



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «БиоХимМак Диагностика»



Пичугина Л.В.


«13» сентября 2024 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии  
Sharay

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay, в составе:

1. Разбавитель образца, флакон 90 мл, 1 шт.
2. Силиконовая крышка для флакона с реагентом, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

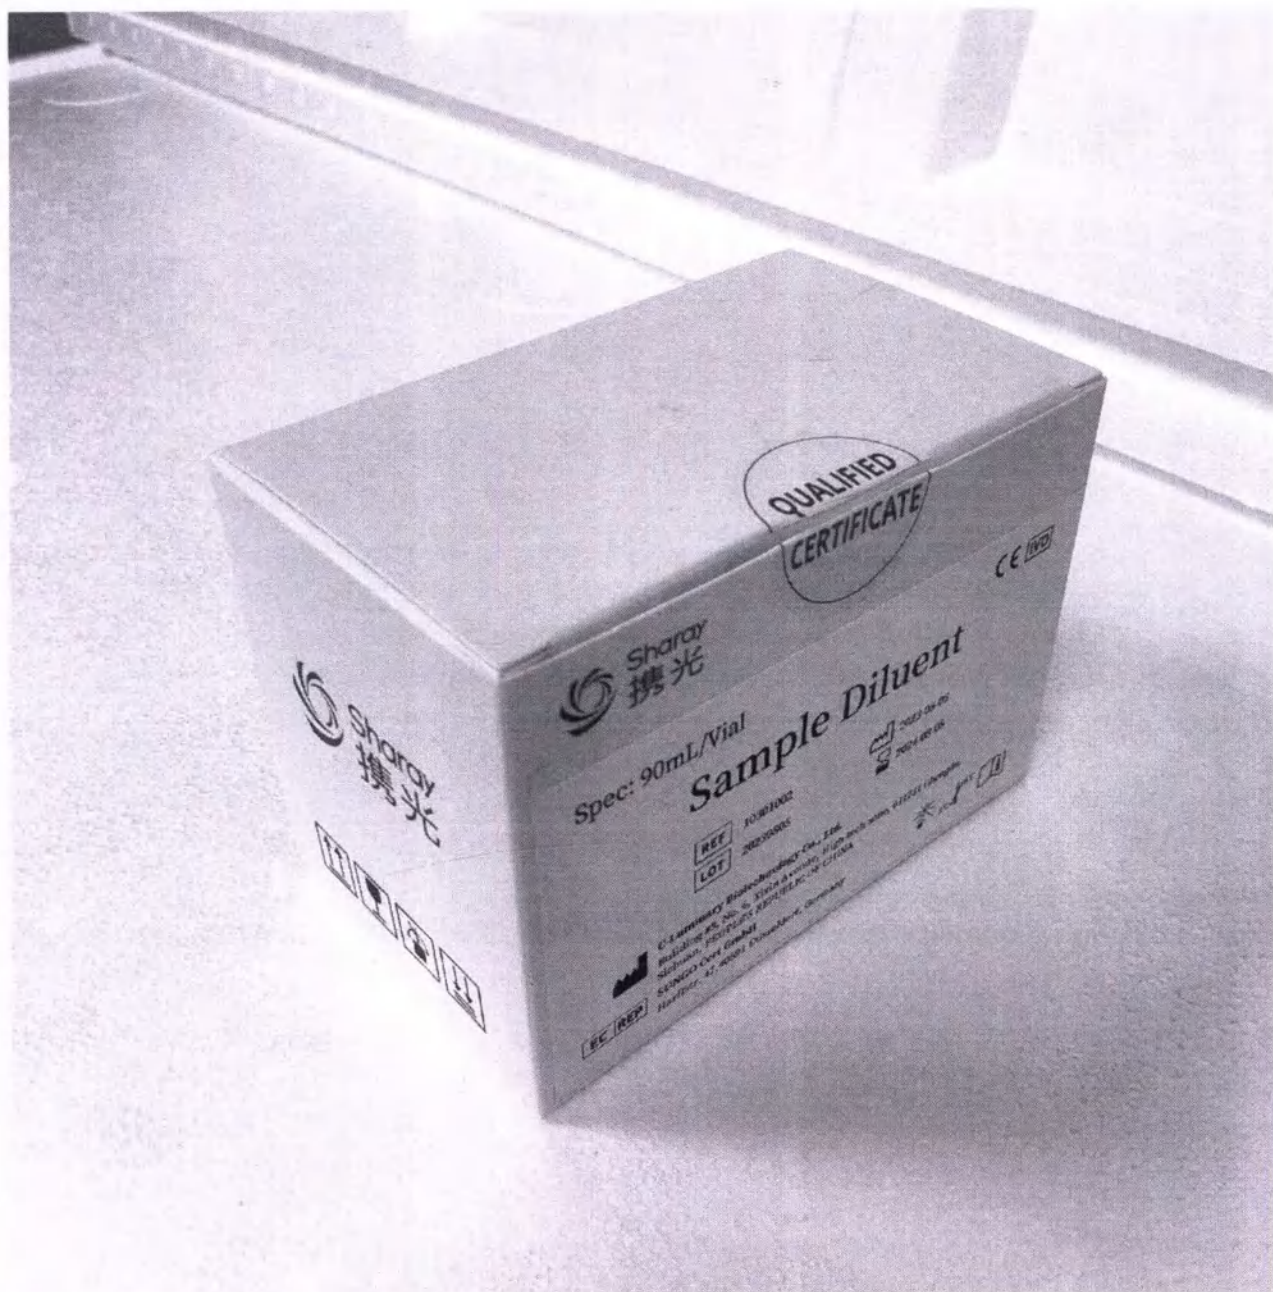

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Общий вид



Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Вид сбоку



Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Вид спереди



Spec: 90mL/Vial

## Sample Diluent

**REF** 10301002

 2023-08-05

 2024-08-05


**LOT** 20230805

**UDI**




(01)06975070763237  
(11)230805 (17)240805  
(10)20230805

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Вид сбоку

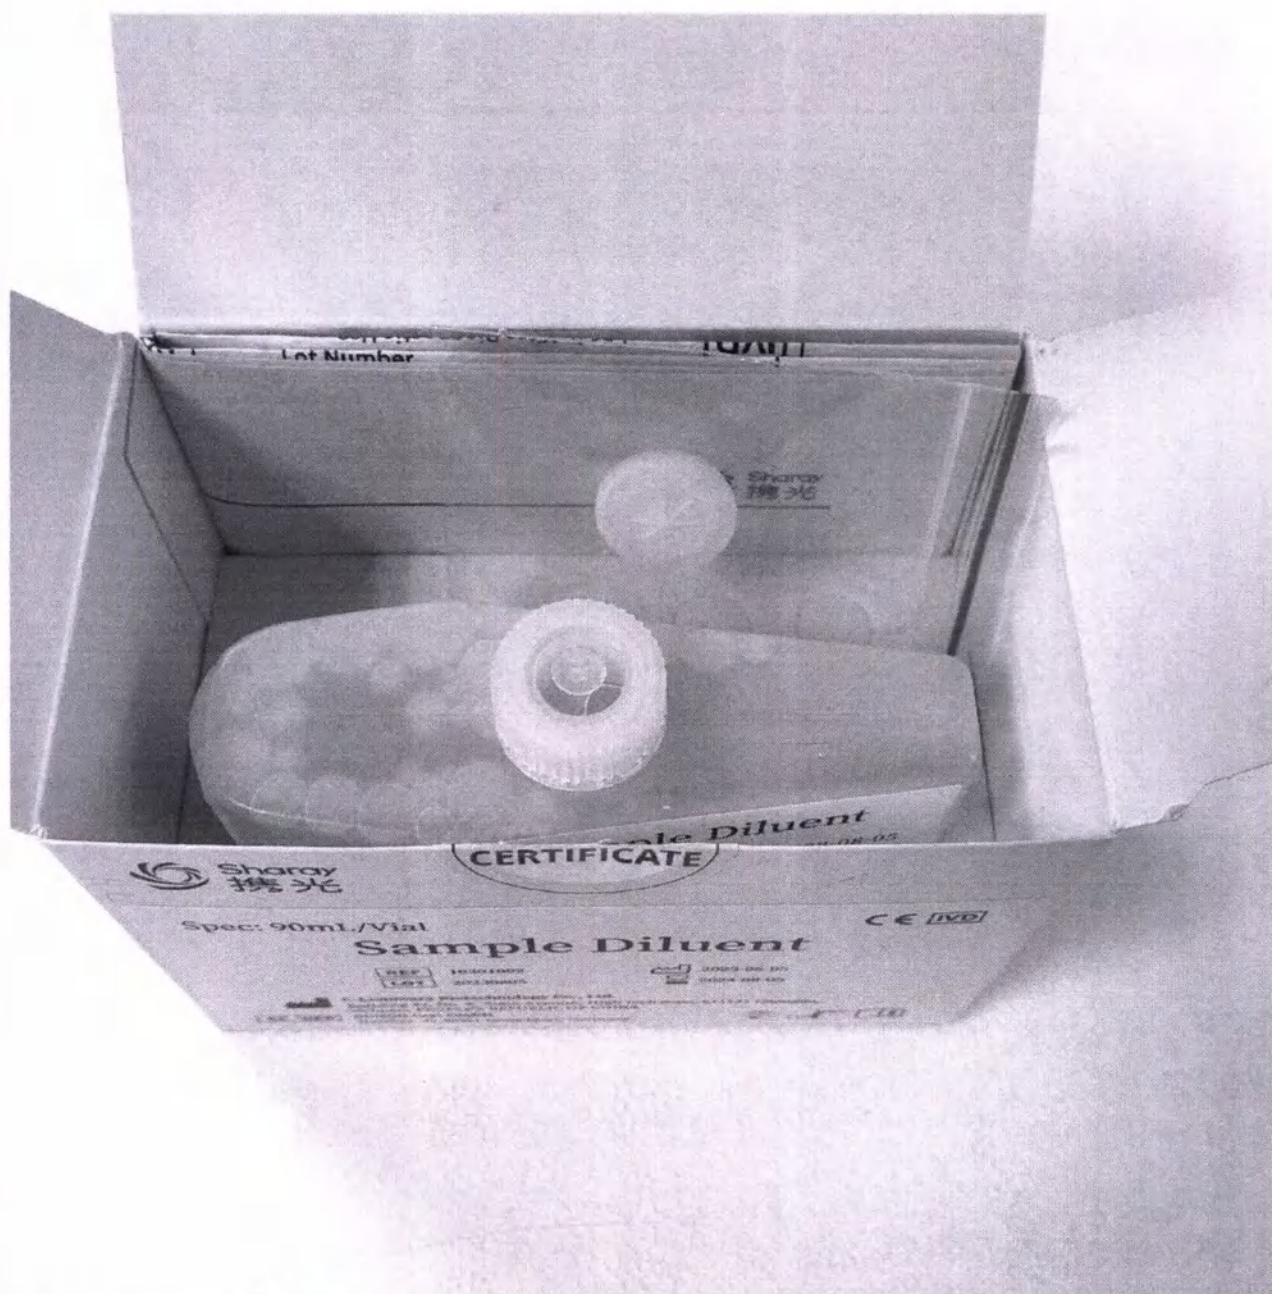

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Общий вид

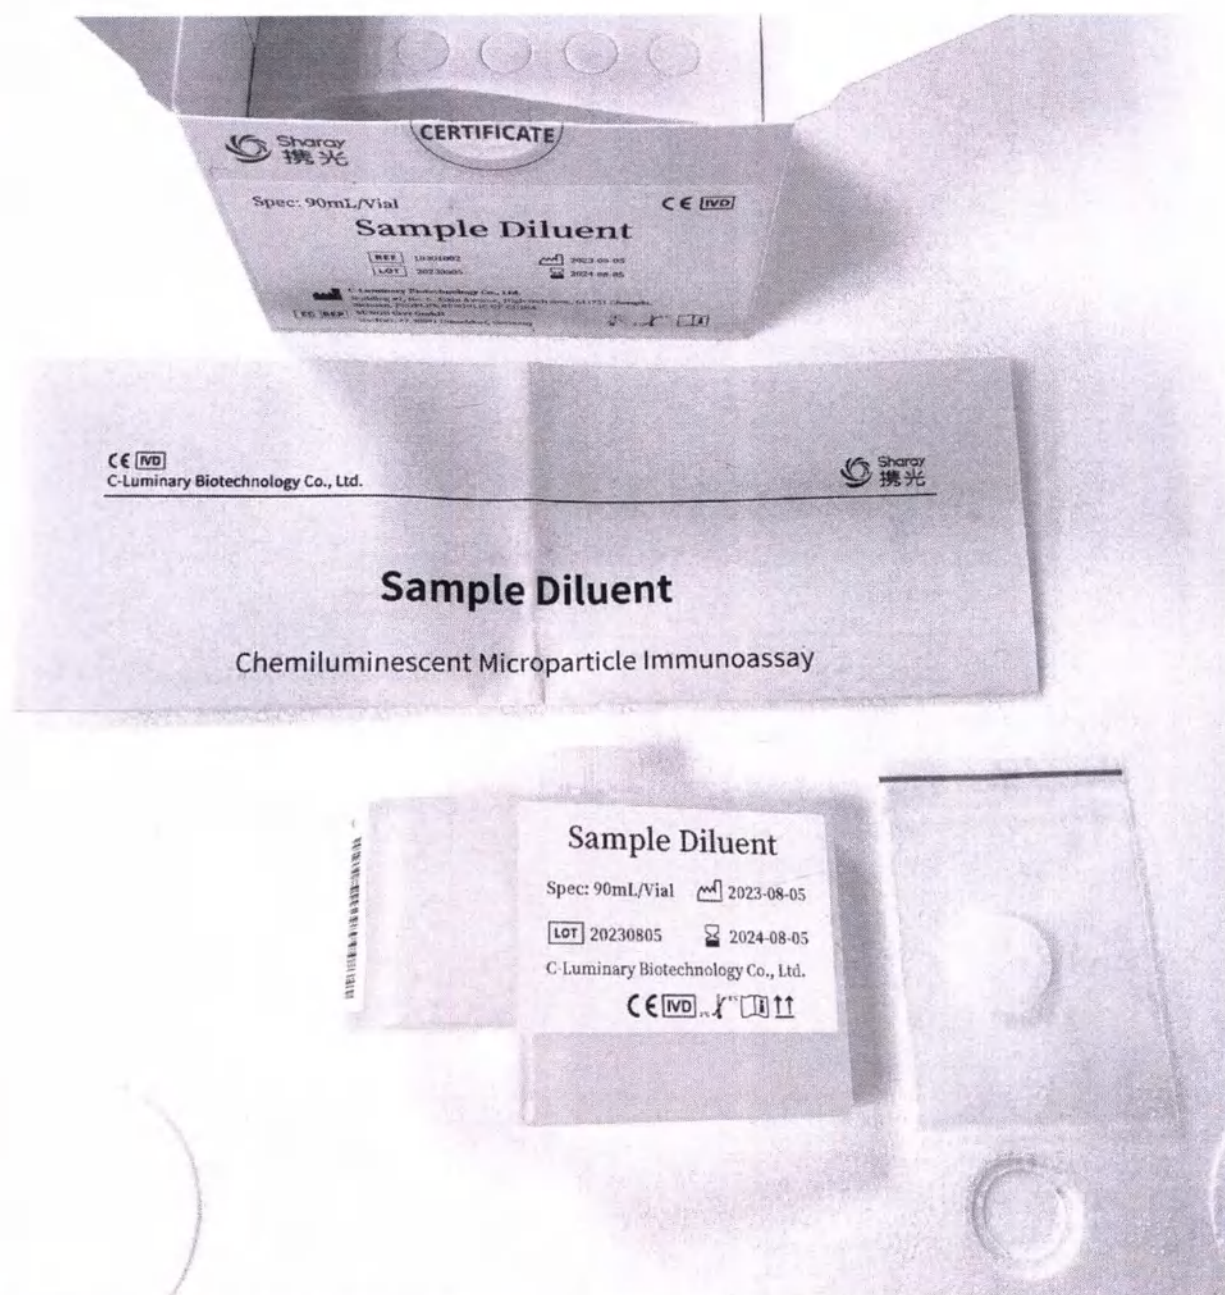


Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Общий вид




1. Разбавитель образца, флакон 90 мл, 1 шт.



1. Разбавитель образца, флакон 90 мл, 1 шт., вид сбоку

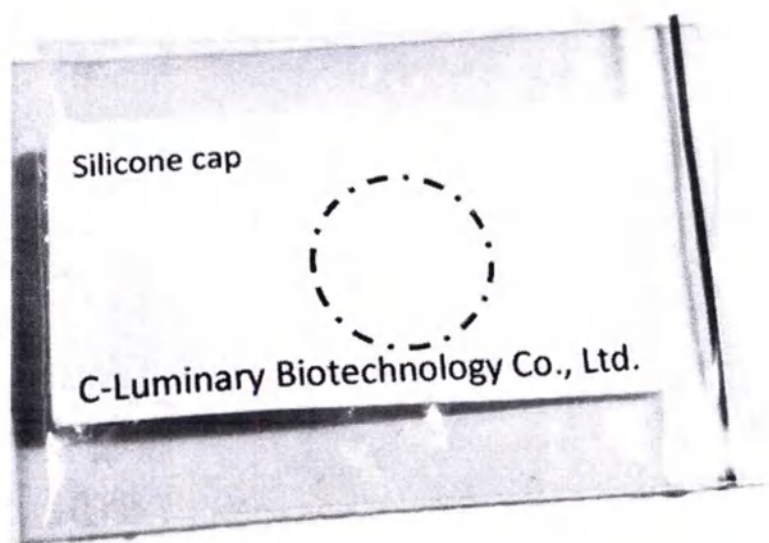

2. Силиконовая крышка для флакона с реагентом, 1 шт., маркировка

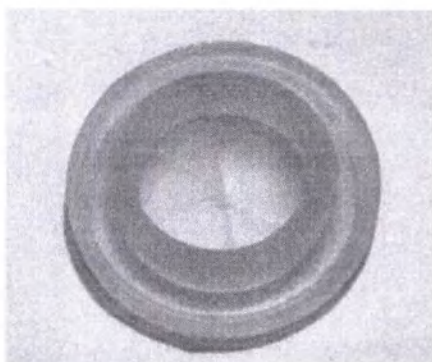

2. Силиконовая крышка для флакона с реагентом, 1 шт., общий вид

Инструкция по применению на медицинское изделие

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay

Используемые символы

|                                                                                   |                                                       |                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Номер по каталогу                                     |  | Использовать до                       |
|  | Медицинское изделие для диагностики in vitro          |  | Код партии                            |
|  | Температурный диапазон (2-8°C)                        |  | Изготовитель                          |
|  | Не допускать воздействия солнечного света             |  | Дата изготовления                     |
|  | Декларация соответствия требованиям ЕС                |  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Уполномоченный Представитель в Европейском сообществе |  | Не допускать воздействия влаги        |
|  | Верх                                                  |  | Хрупкое, обращаться осторожно         |
|  | Уникальный идентификатор изделия                      |  | Не допускать чрезмерного сжатия       |
|                                                                                   |                                                       |  | Не касаться                           |

Для применения в диагностике in vitro.  
Для профессионального применения.



Дата выпуска: 2024/07  
Версия: A.2

 C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.  
(Ц-Люминерн Биотехнологджи Ко., Лтд.)

Адрес: Building #3, No.6, Xixin Avenue, Hight-tech Zone, 611731 Chengdu, Sichuan,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
(Китайская Народная Республика, провинция Сычуань, 611731, город  
Чэнду, Зона хай-тек, улица Сисинь, дом 6, строение 3)  
Тел.: + 86 028 8798 7800  
E-mail: service@c-luminary.com

3. Инструкция по применению, 1 шт.

Групповая (Транспортная) упаковка:

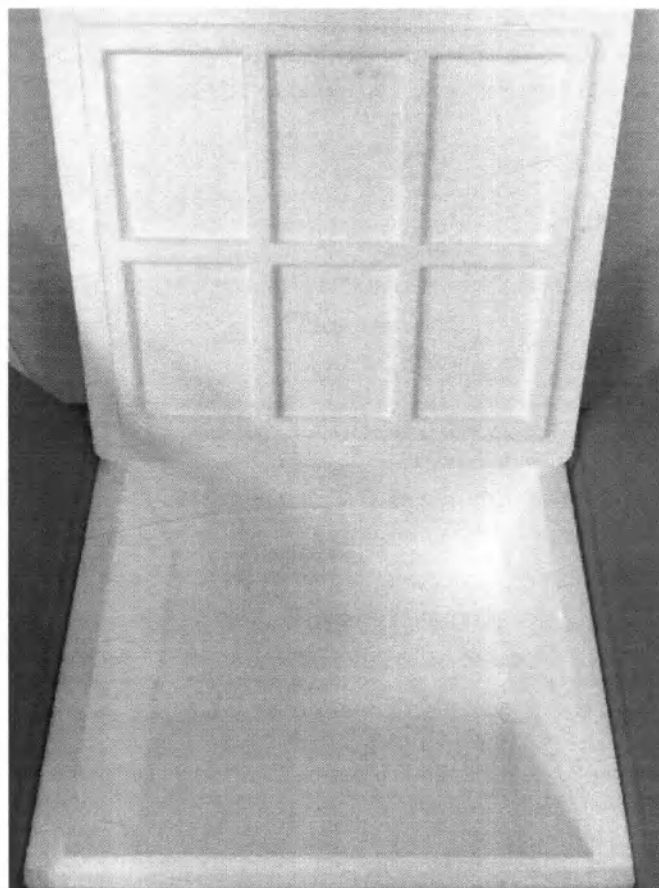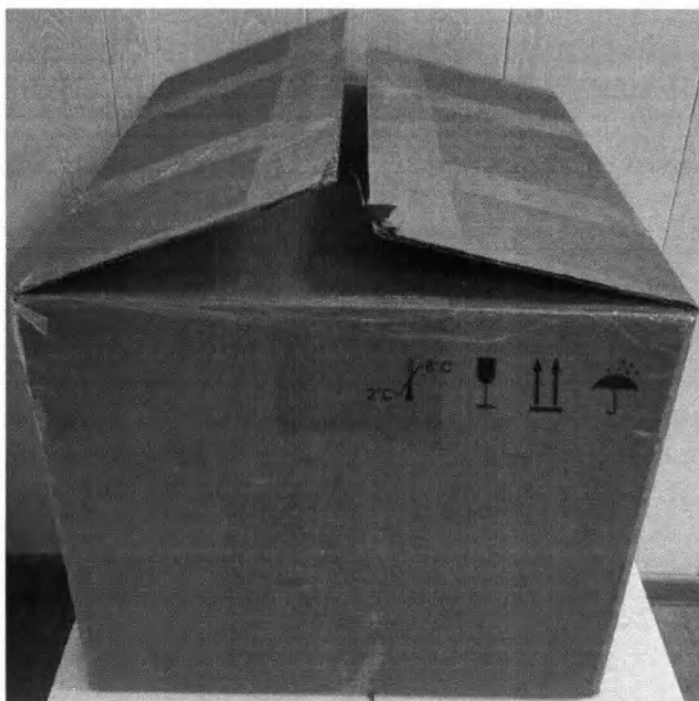

**Макет маркировки групповой (транспортной) упаковки с изделием:**

Product name / Наименование:

Sample diluent, for immunochemiluminescent analyzers of the Sharay series

/ Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay

Manufacturer / Изготовитель:

C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.

(Ц-Люминери Биотехнолоджи Ко., Лтд.)

Manufacturer's address / Адрес изготовителя:

Building #3, No.6, Xixin Avenue, Hight-tech Zone, 611731 Chengdu, Sichuan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(Китайская Народная Республика, провинция Сычуань, 611731, город Чэнду, Зона хай-тек, улица Сисинь, дом 6, строение 3)

Date of manufacture / Дата изготовления: XX/XX/XXXX

Expiration date / Срок годности: XX/XX/XXXX



Batch code / Код партии: \_\_\_\_\_ Рег. Удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Catalogue number / Номер по каталогу: \_\_\_\_\_

Transportation and storage requirements of transport packaging / Требования к транспортировке и хранению транспортной упаковки с изделием:

To be transport between 2-8°C temperature / Транспортировать в диапазоне температур 2-8°C.

On arrival store between 2-8°C temperature / По прибытии хранить в диапазоне температур 2-8°C.



From /

Отправитель: \_\_\_\_\_

To /

Получатель: \_\_\_\_\_

Total number consumer packages in the transport package / Общее количество потребительских упаковок в транспортной упаковке \_\_\_\_\_ pcs. / шт.

Net weight of the transport package / Масса нетто транспортной упаковки: \_\_\_\_\_ kg / кг

Gross weight of the transport package / Масса брутто транспортной упаковки: \_\_\_\_\_ kg / кг

Net weight of consumer packaging / Масса нетто потребительской упаковки: \_\_\_\_\_ kg / кг

## Макет русскоязычного стикера для медицинского изделия

Разбавитель образца Sample diluent, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay, в составе:

1. Разбавитель образца, флакон 90 мл, 1 шт.
2. Силиконовая крышка для флакона с реагентом, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для профессионального применения!**

**Для диагностики in vitro!**

Производитель: *C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.*  
(Ц-Люминери Биотехнологджи Ко., Лтд.)

*Building #3, No.6, Xixin Avenue, Hight-tech Zone, 611731  
Chengdu, Sichuan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
(Китайская Народная Республика, провинция Сычуань,  
611731, город Чэнду, Зона хай-тек, улица Сисинь, дом 6,  
строение 3)*

*Тел. + 86 028 8798 7800, E-mail: service@c-luminary.com*

Уполномоченный  
представитель в РФ: *Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика», 119311, г.  
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, пр-кт  
Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3  
тел.: +7 (495) 647-27-40;  
E-mail: info@biochemmack.ru  
Веб-сайт: www.biochemmack.ru*

Регистрационное  
удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Символы, применяемые при маркировке медицинского изделия, указаны на  
оригинальной упаковке. Наименование изделия на настоящем стикере считается  
приоритетным на территории Российской Федерации*



Прошито, пронум  
скреплено печать  
Генеральный дир  
АО «БиоХимМак»  
Пичугина Л.В.