



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «БиоХимМак Диагностика»



Пичугина Л.В.

«13» сентября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии Sharay

Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay в составе:

- 1. Буфер для очистки иглы дозатора, флакон 70 мл, 1 шт.**
- 2. Инструкция по применению, 1 шт.**



Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Общий вид



Spec:70mL



Maintenance Wash Buffer A

REF 23204002


2023-08-14

LOT 20230814

2024-08-14



C-luminary Biotechnology Co., Ltd.
Building #3, No.6, Xixin Avenue, Hight-tech Zone, 611731 Chengdu,
Sichuan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Вид спереди

Spec:70mL

IVD

Maintenance Wash Buffer A


REF 23204002

 2023-08-14


 2024-08-14

LOT 20230814

Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Вид сбоку

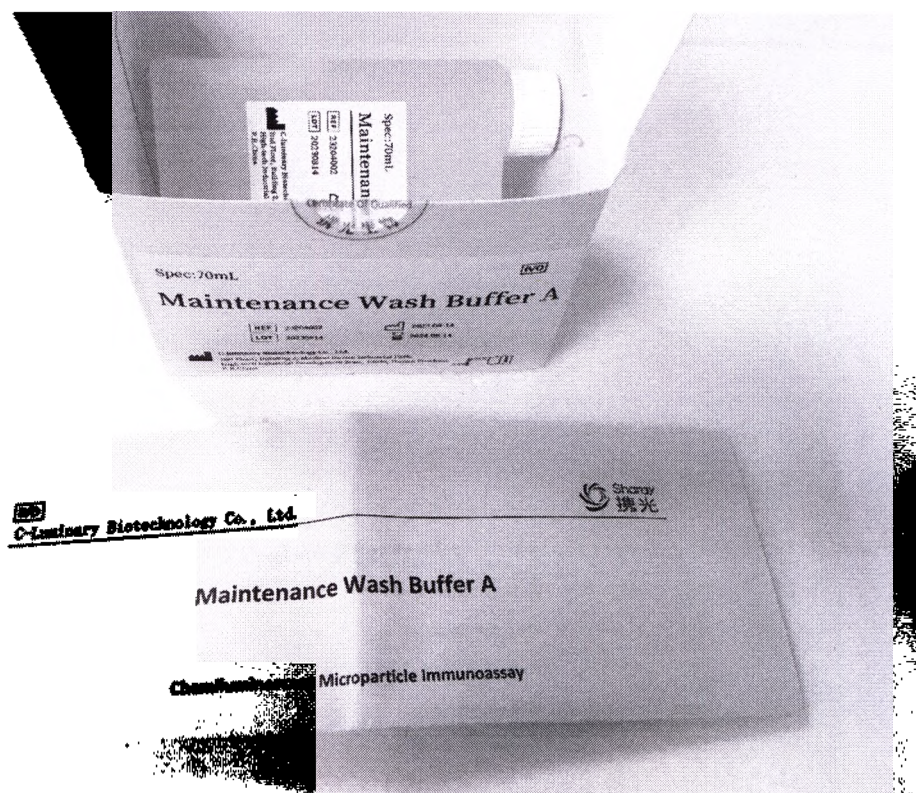

Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay. Общий вид

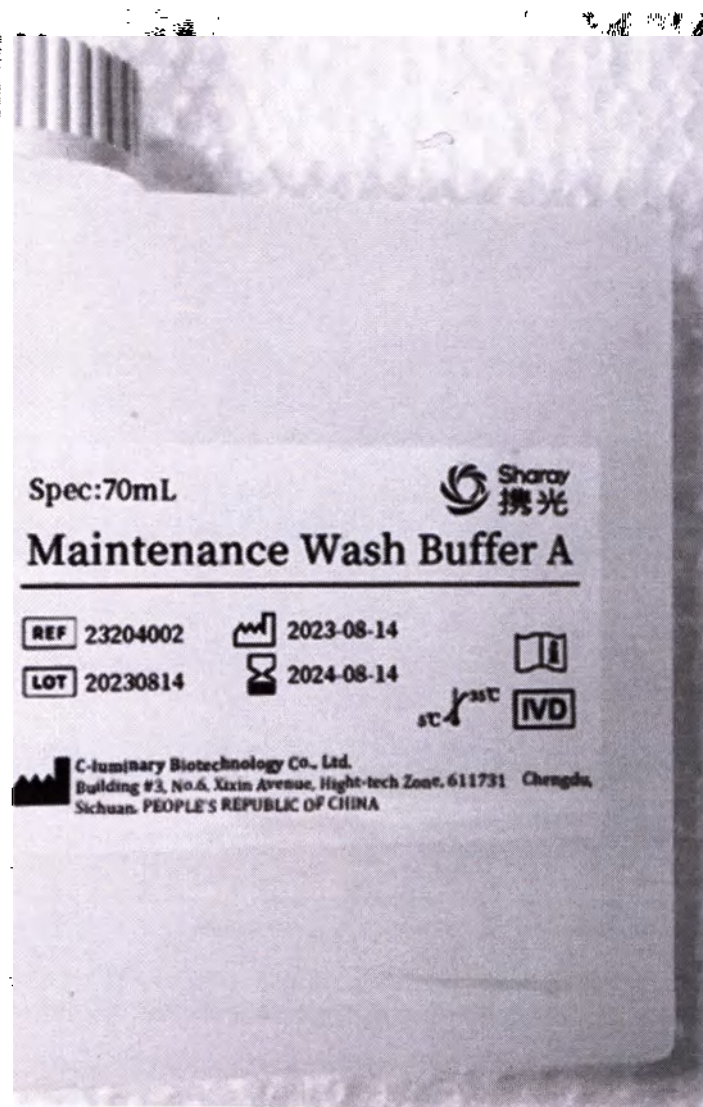

1. Буфер для очистки иглы дозатора, флакон 70 мл, 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Буфер для очистки иглы дилатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов
иммунохимических серий Shanyou

Используемые символы

	Номер по каталогу		Использовать до
	Медицинское изделие для диагностики in vitro		Код партии
	Температурный диапазон (5-35°C)		Изготовитель
	Не допускать воздействия влаги		Дата изготовления
	Хрупкое, обращаться осторожно		Обратитесь к инструкции по применению
	Верх		

Для применения в диагностике in vitro.
Для профессионального применения.

Дата выпуска: _____
Версия: _____



C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.
(Ц-Люминери Биотехнологиз Ко., Лта.)



Адрес: Building #3, No.6, Xixin Avenue, High-tech Zone, 611731 Chengdu, Sichuan,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
(Китайская Народная Республика, провинция Сычуань, 611731, город
Чэнду, Зона хай-тек, улица Сиксинь, дом 6, строение 3)

Тел.: +86 (028) 8798 7800

E-mail: service@c-luminary.com

2. Инструкция по применению, 1 шт.

Групповая (Транспортная) упаковка:

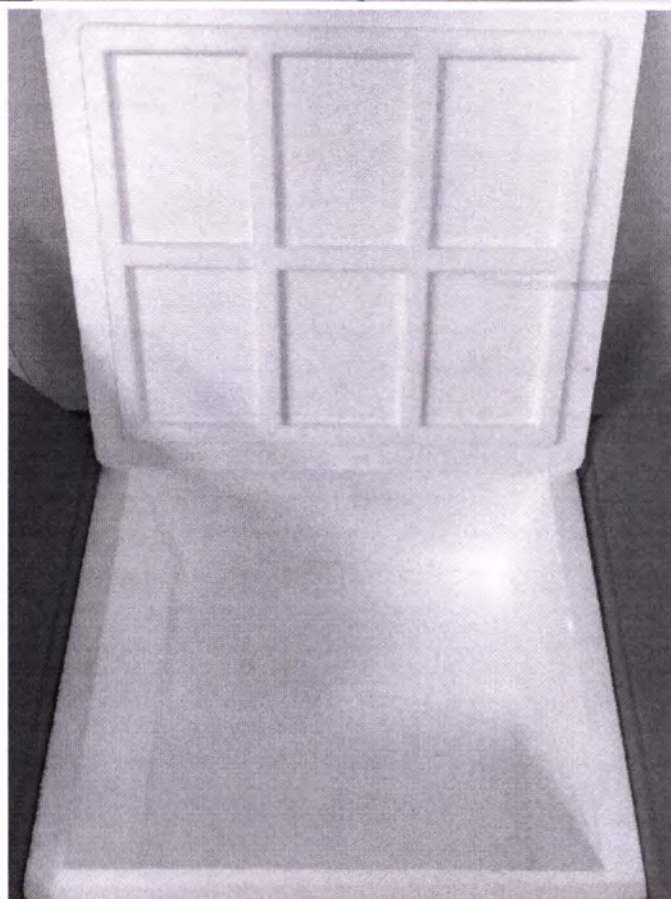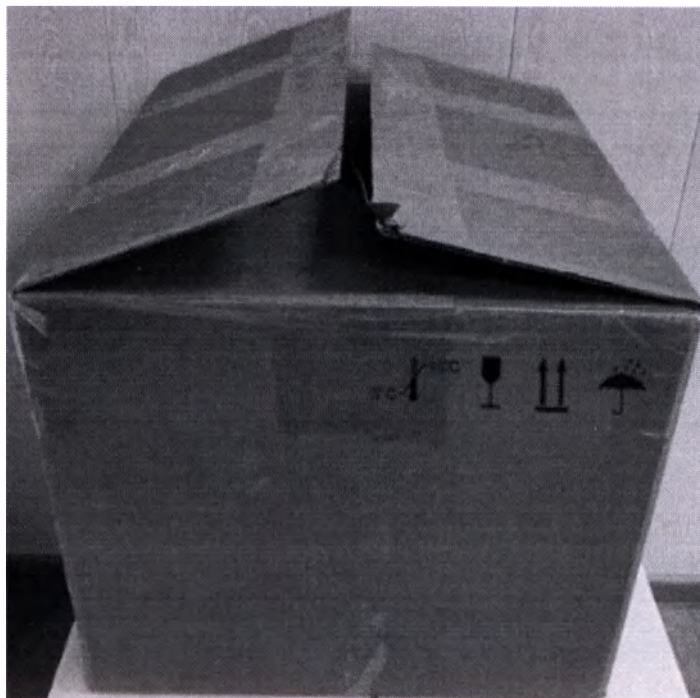

Макет маркировки групповой (транспортной) упаковки с изделием:

Product name / Наименование:

Maintenance Wash Buffer A, for immunochemiluminescent analyzers of the Sharay series
/ Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии Sharay

Manufacturer / Изготовитель:

C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.

(Ц-Люминери Биотехнолоджи Ко., Лтд.) **Manufacturer's address / Адрес изготовителя:**

Building #3, No.6, Xixin Avenue, Hight-tech Zone, 611731 Chengdu, Sichuan, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

(Китайская Народная Республика, провинция Сычуань, 611731, город Чэнду, Зона хай-тек,
улица Сисинь, дом 6, строение 3)

Date of manufacture / Дата изготовления: XX/XX/XXXX

Expiration date / Срок годности: XX/XX/XXXX

Batch code / Код партии: _____ **Reg. Удостоверение №** _____ **от** _____

Catalogue number / Номер по каталогу: _____

**Transportation and storage requirements of transport packaging / Требования к
транспортировке и хранению транспортной упаковки с изделием:**

To be transport between 5-35°C temperature / Транспортировать в диапазоне температур 5-35°C.

On arrival store between 5-35°C temperature/ По прибытии хранить в диапазоне температур 5-35°C



From /

Отправитель: _____

To /

Получатель: _____

**Total number consumer packages in the transport package / Общее количество
потребительских упаковок в транспортной упаковке** _____ **pcs. / шт.**

Net weight of the transport package / Масса нетто транспортной упаковки: _____ **kg / кг**

Gross weight of the transport package / Масса брутто транспортной упаковки: _____ **kg / кг**

Net weight of consumer packaging / Масса нетто потребительской упаковки: _____ **kg / кг**

Макет русскоязычного стикера для медицинского изделия

Буфер для очистки иглы дозатора Maintenance Wash Buffer A, для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии Sharay в составе:

1. Буфер для очистки иглы дозатора, флакон 70 мл, 1 шт.
2. Инструкция по применению, 1 шт.

Только для профессионального применения!

Для диагностики in vitro!

Производитель: *C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.*
(Ц-Люминери Биотехнолоджи Ко., Лтд.)
Building #3, No.6, Xixin Avenue, Hight-tech Zone, 611731
Chengdu, Sichuan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
(Китайская Народная Республика, провинция Сычуань,
611731, город Чэнду, Зона хай-тек, улица Сисинь, дом 6,
строение 3)
Тел. + 86 028 8798 7800, E-mail: service@c-luminary.com

Уполномоченный представитель в РФ: *Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика», 119311, г.*
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, пр-кт
Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел.: +7 (495) 647-27-40;
E-mail: info@biochemmack.ru
Веб-сайт: www.biochemmack.ru

Регистрационное удостоверение № от

Символы, применяемые при маркировке медицинского изделия, указаны на оригинальной упаковке. Наименование изделия на настоящем стикере считается приоритетным на территории Российской Федерации

Прошито, пронум
скреплено печат
Генеральный ди
АО «БиоХимМак
Пичугина Л.В.

