


Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз


Денисенко Е.А.
«05» апреля 2024 г.

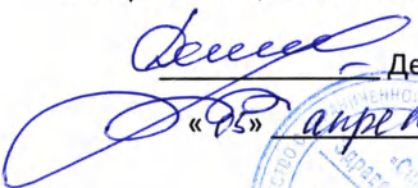

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах
биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E))



Рисунок 1. Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E))



Рисунок 2. Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 1

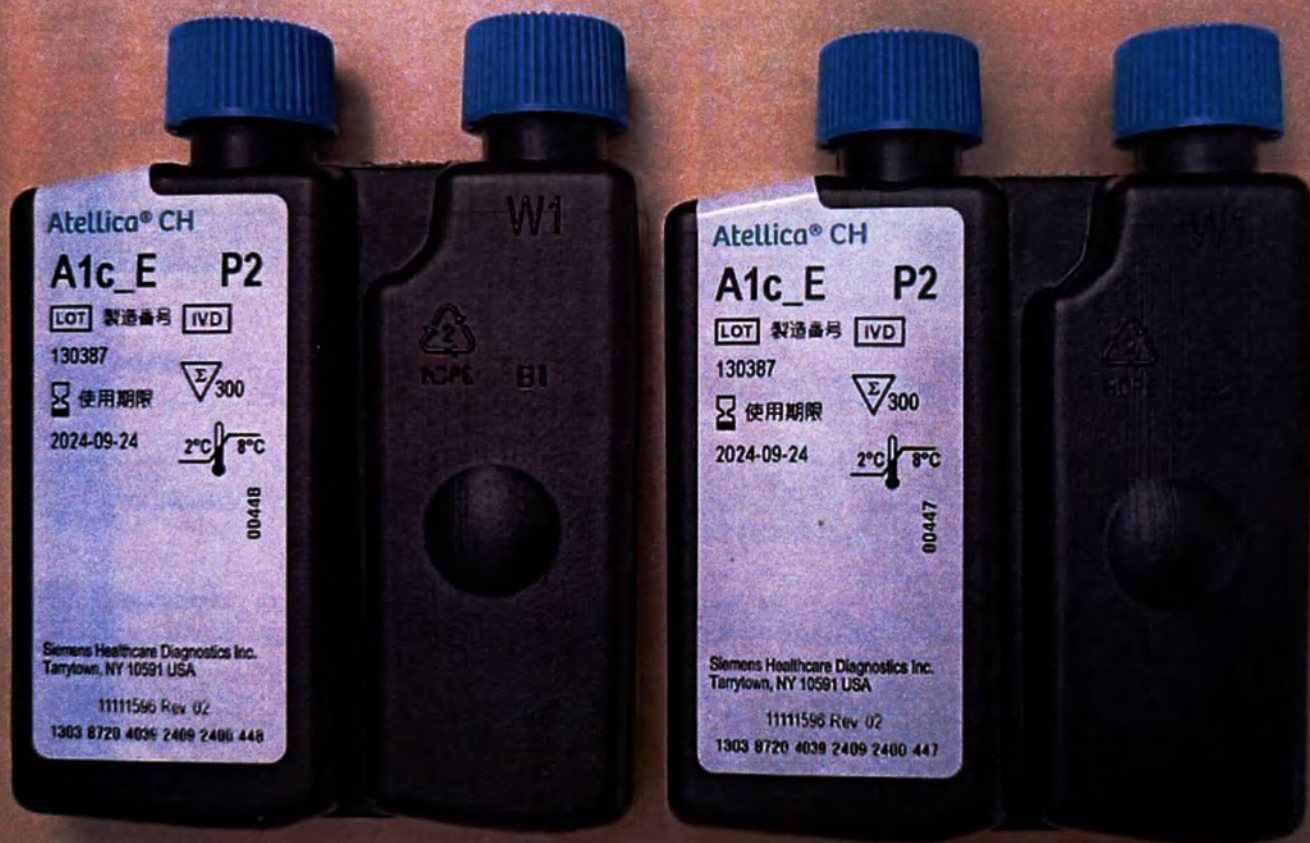


Рисунок 3 Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.

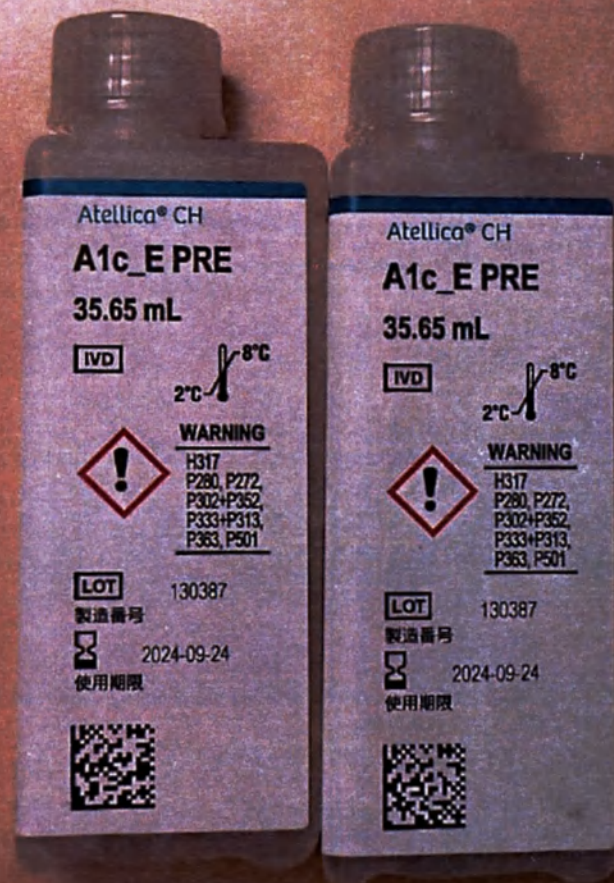


Рисунок 4 Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E)): Флакон 1 (Atellica CH A1c_E PRE)



Рисунок 5 Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E)); вторичная упаковка.

11097536

Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E))

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/10538 от XX.XX.XXXX

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Наименование и адрес УПП

Тел.: 8(XXX) XXX-XX-XX

Рисунок 6. Макет маркировки для РФ для МИ «Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (Atellica CH A1c_E))»

Всего прошито и пронумеровано
7 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

