



Общество с ограниченной ответственностью
«Азиямедконсалт»
Россия, 109004, Москва, ул. А. Солженицына, д. 27
Тел.: +7 495 988 47 44
ОГРН: 1137746433879
ИНН: 7709929540

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»



Перцева Н.Н.

«19» августа 2024

Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный

AutoLumo A2000 Plus с принадлежностями




1. Блок анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного AutoLumo A2000 Plus




2. Кабель питания




3. Руководство по эксплуатации

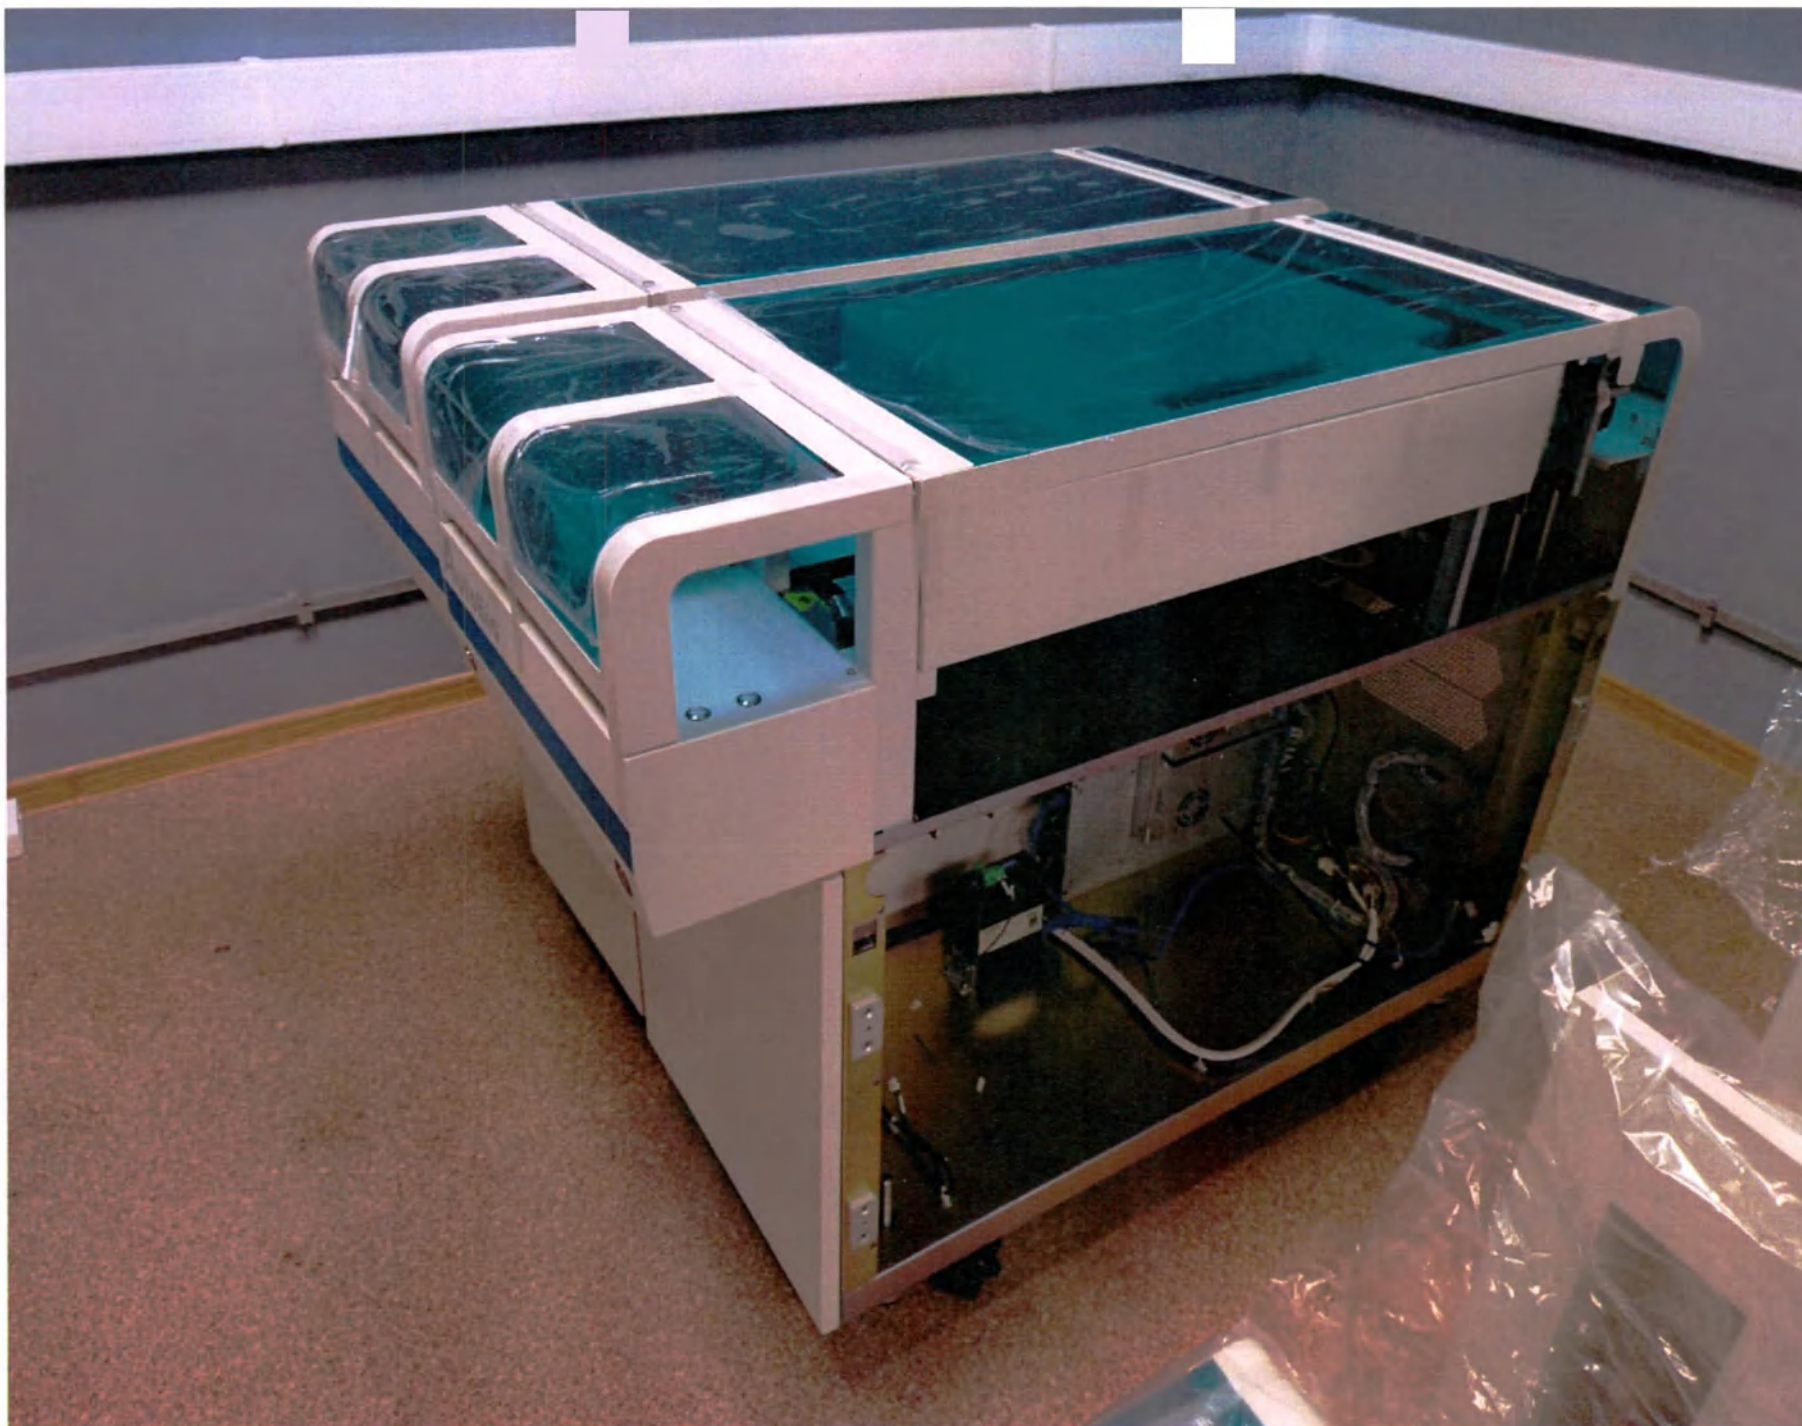

4. Модуль «Sample delivery management» (SDM)

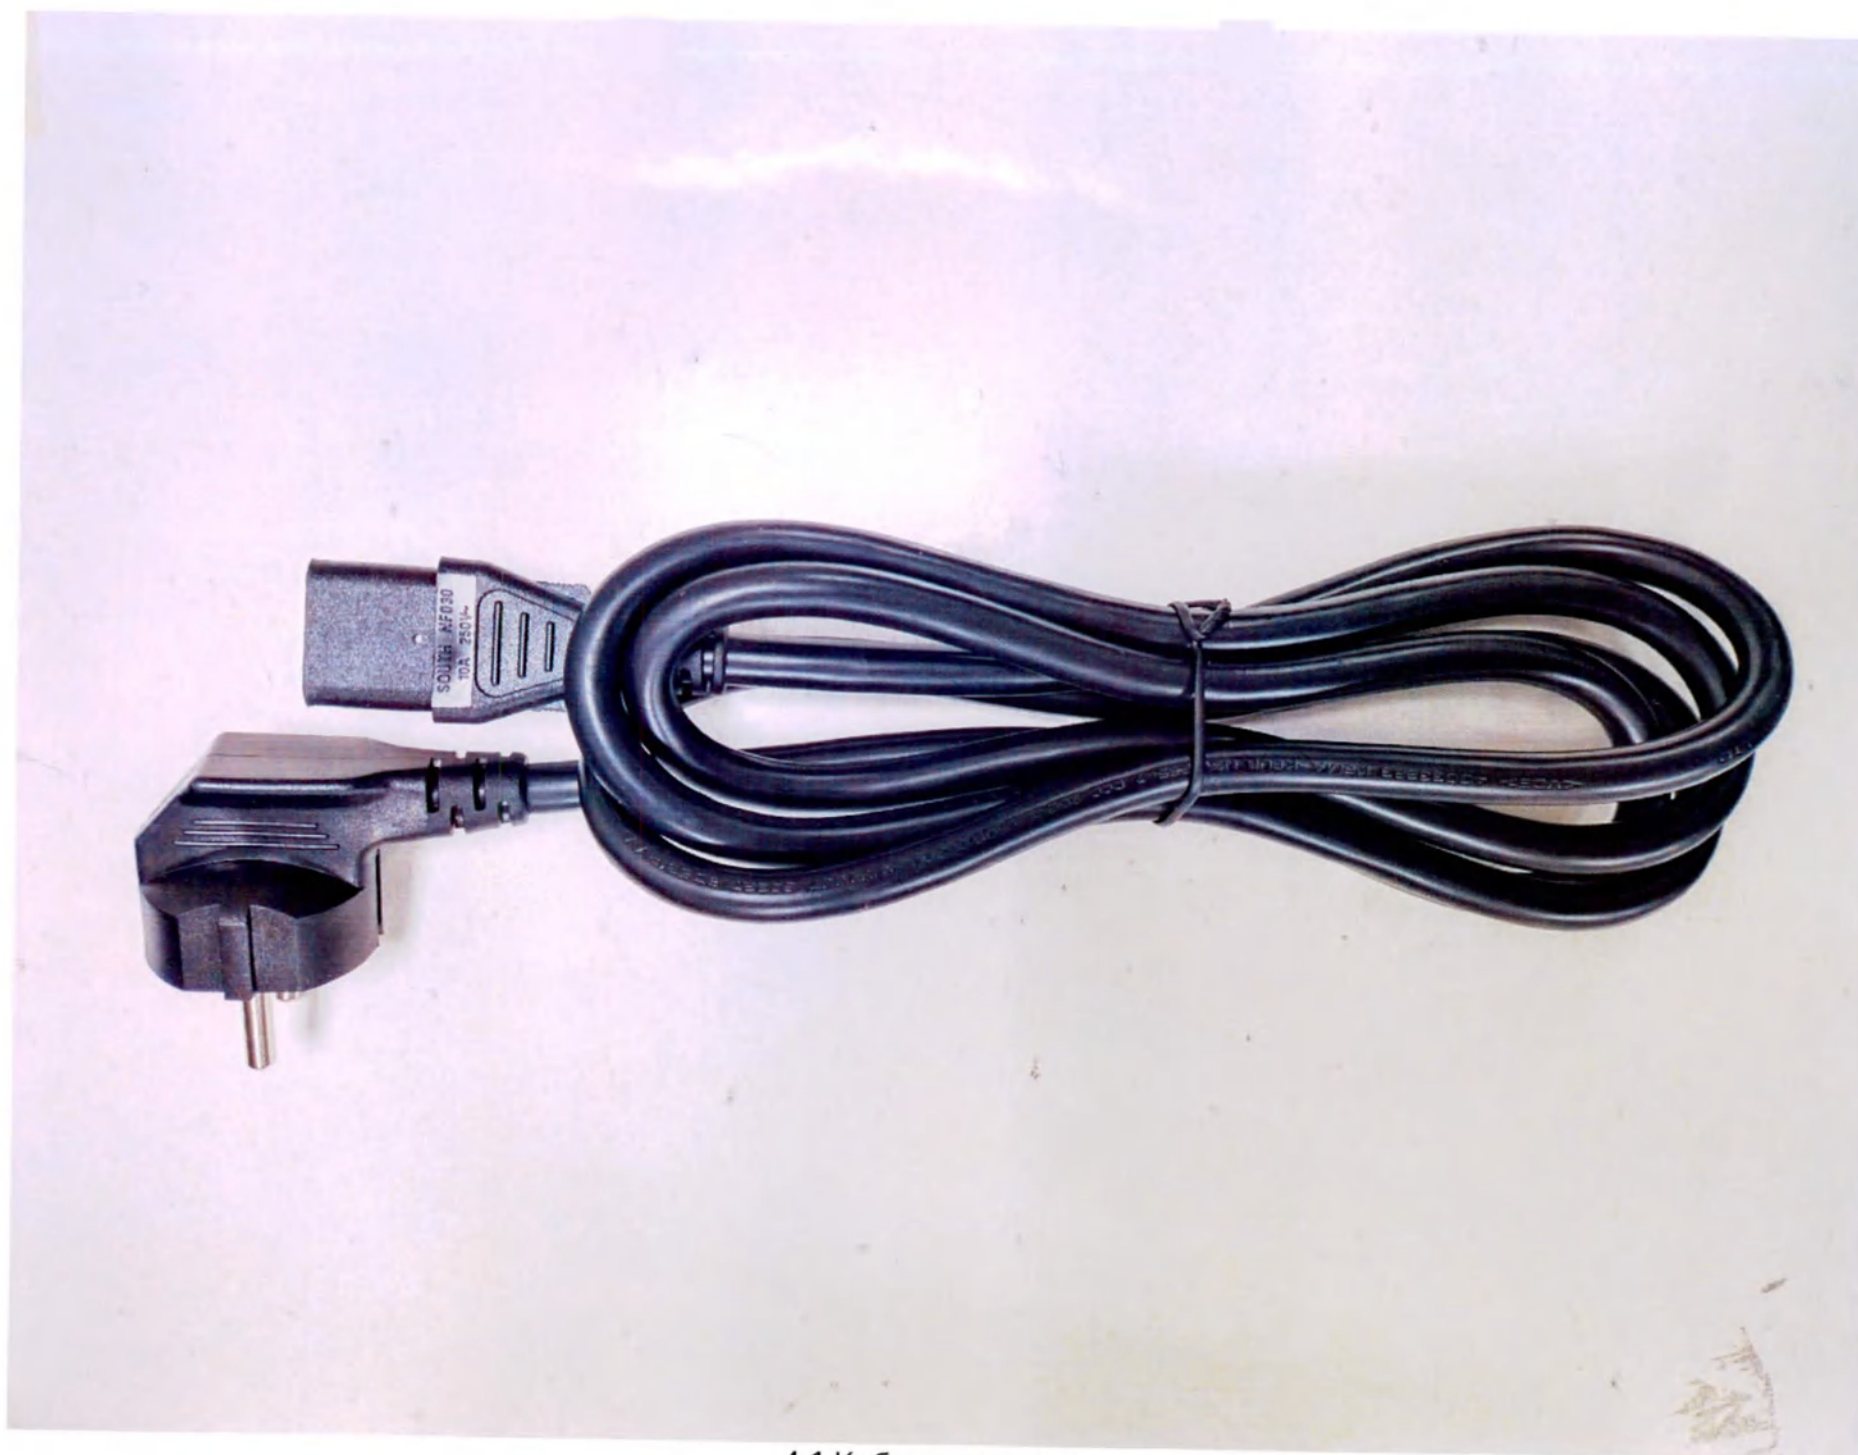

4.1 Кабель питания

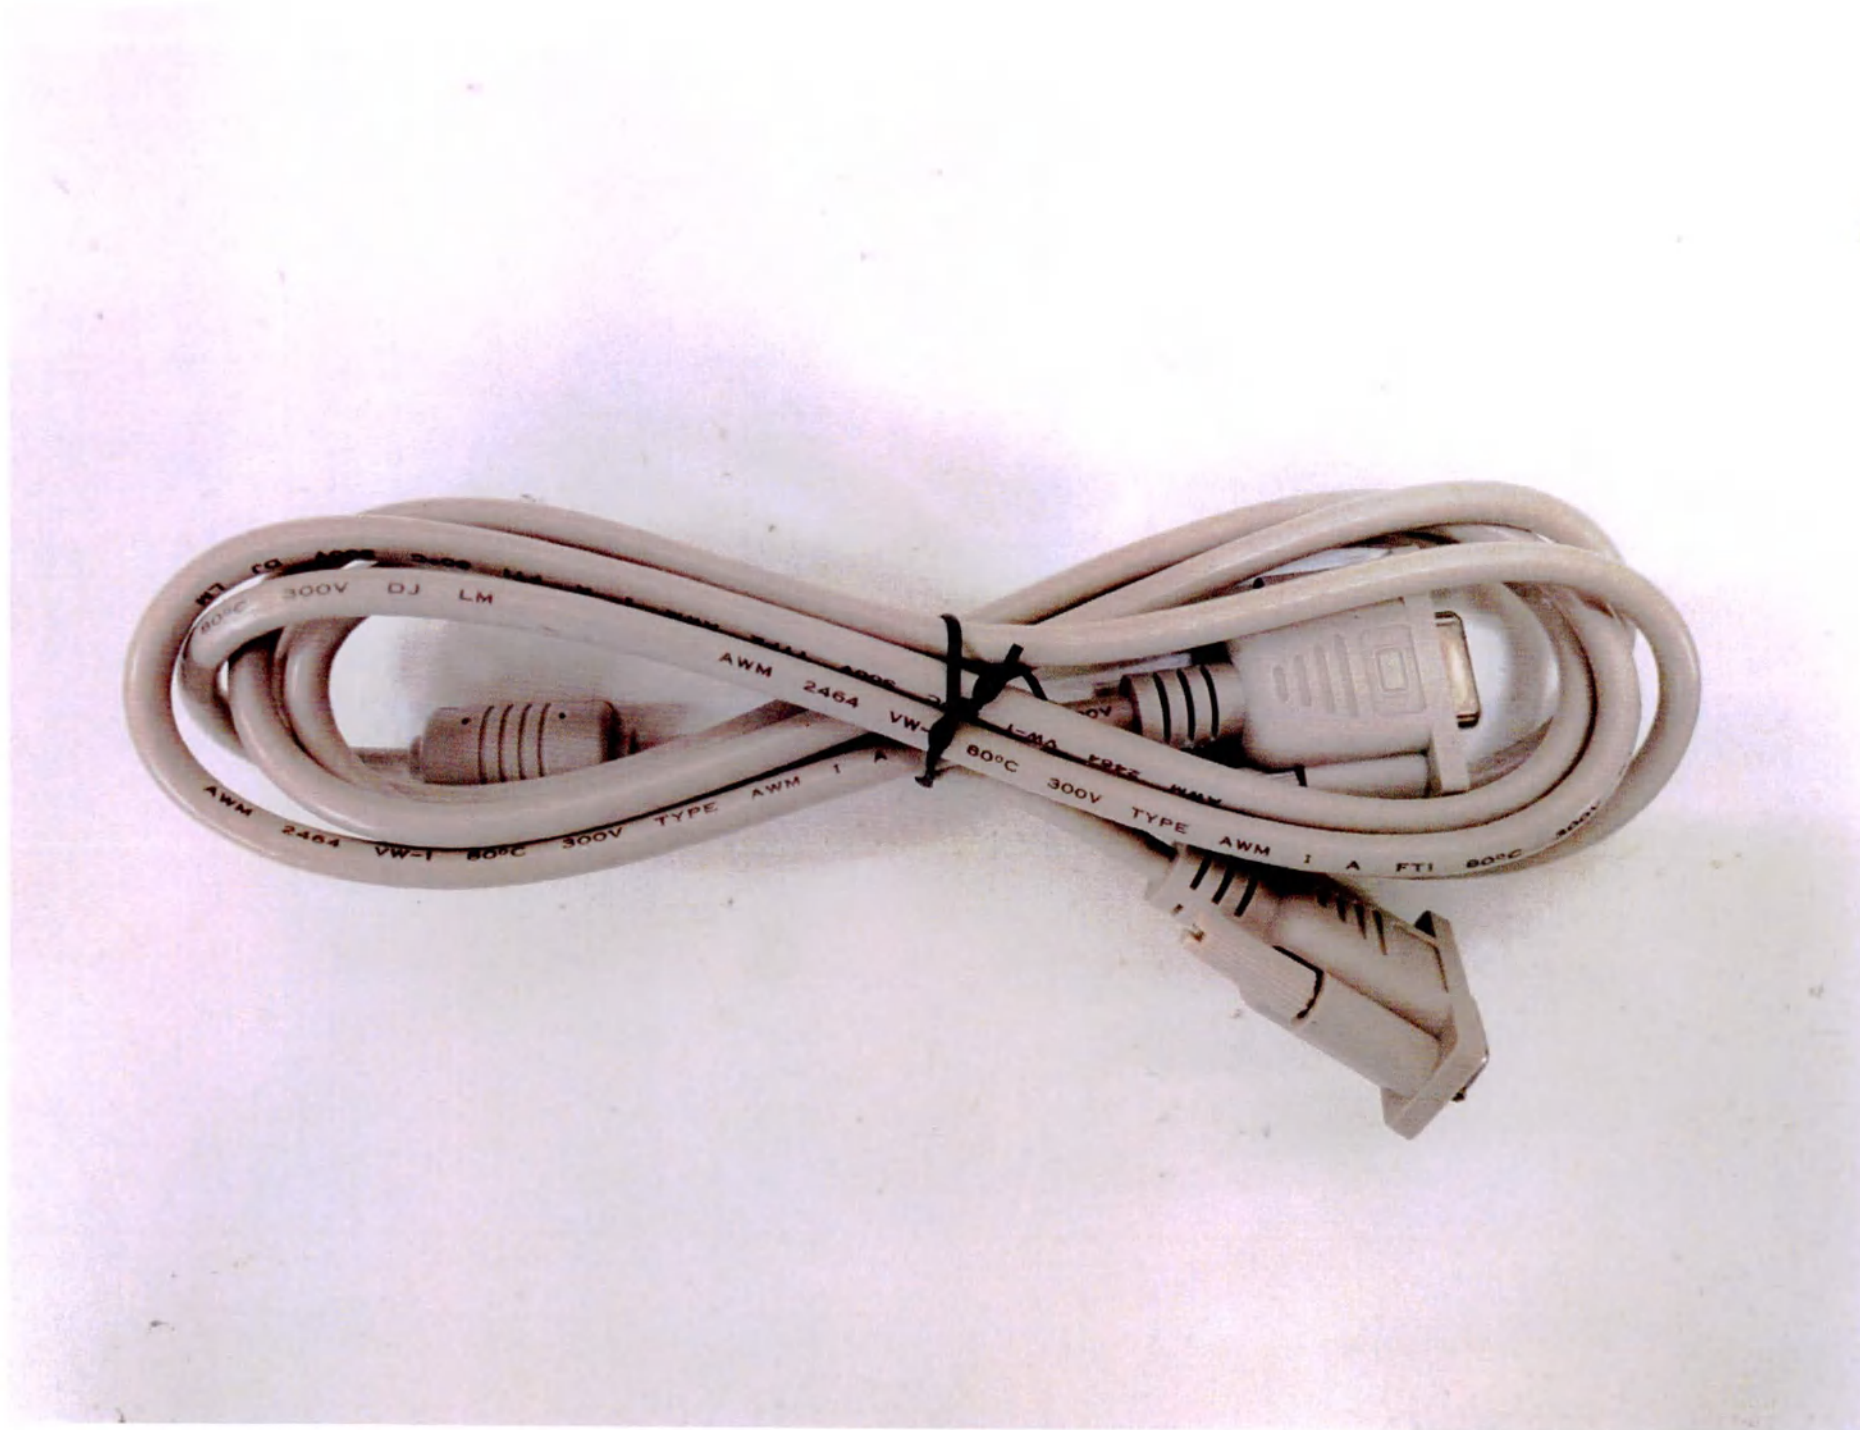

4.2 Кабель RS-232



4.3 Кабель LAN сетевой (3,0 м)


№43




4.4 Лента рулонная (2,0 м)



4.5 Лоток

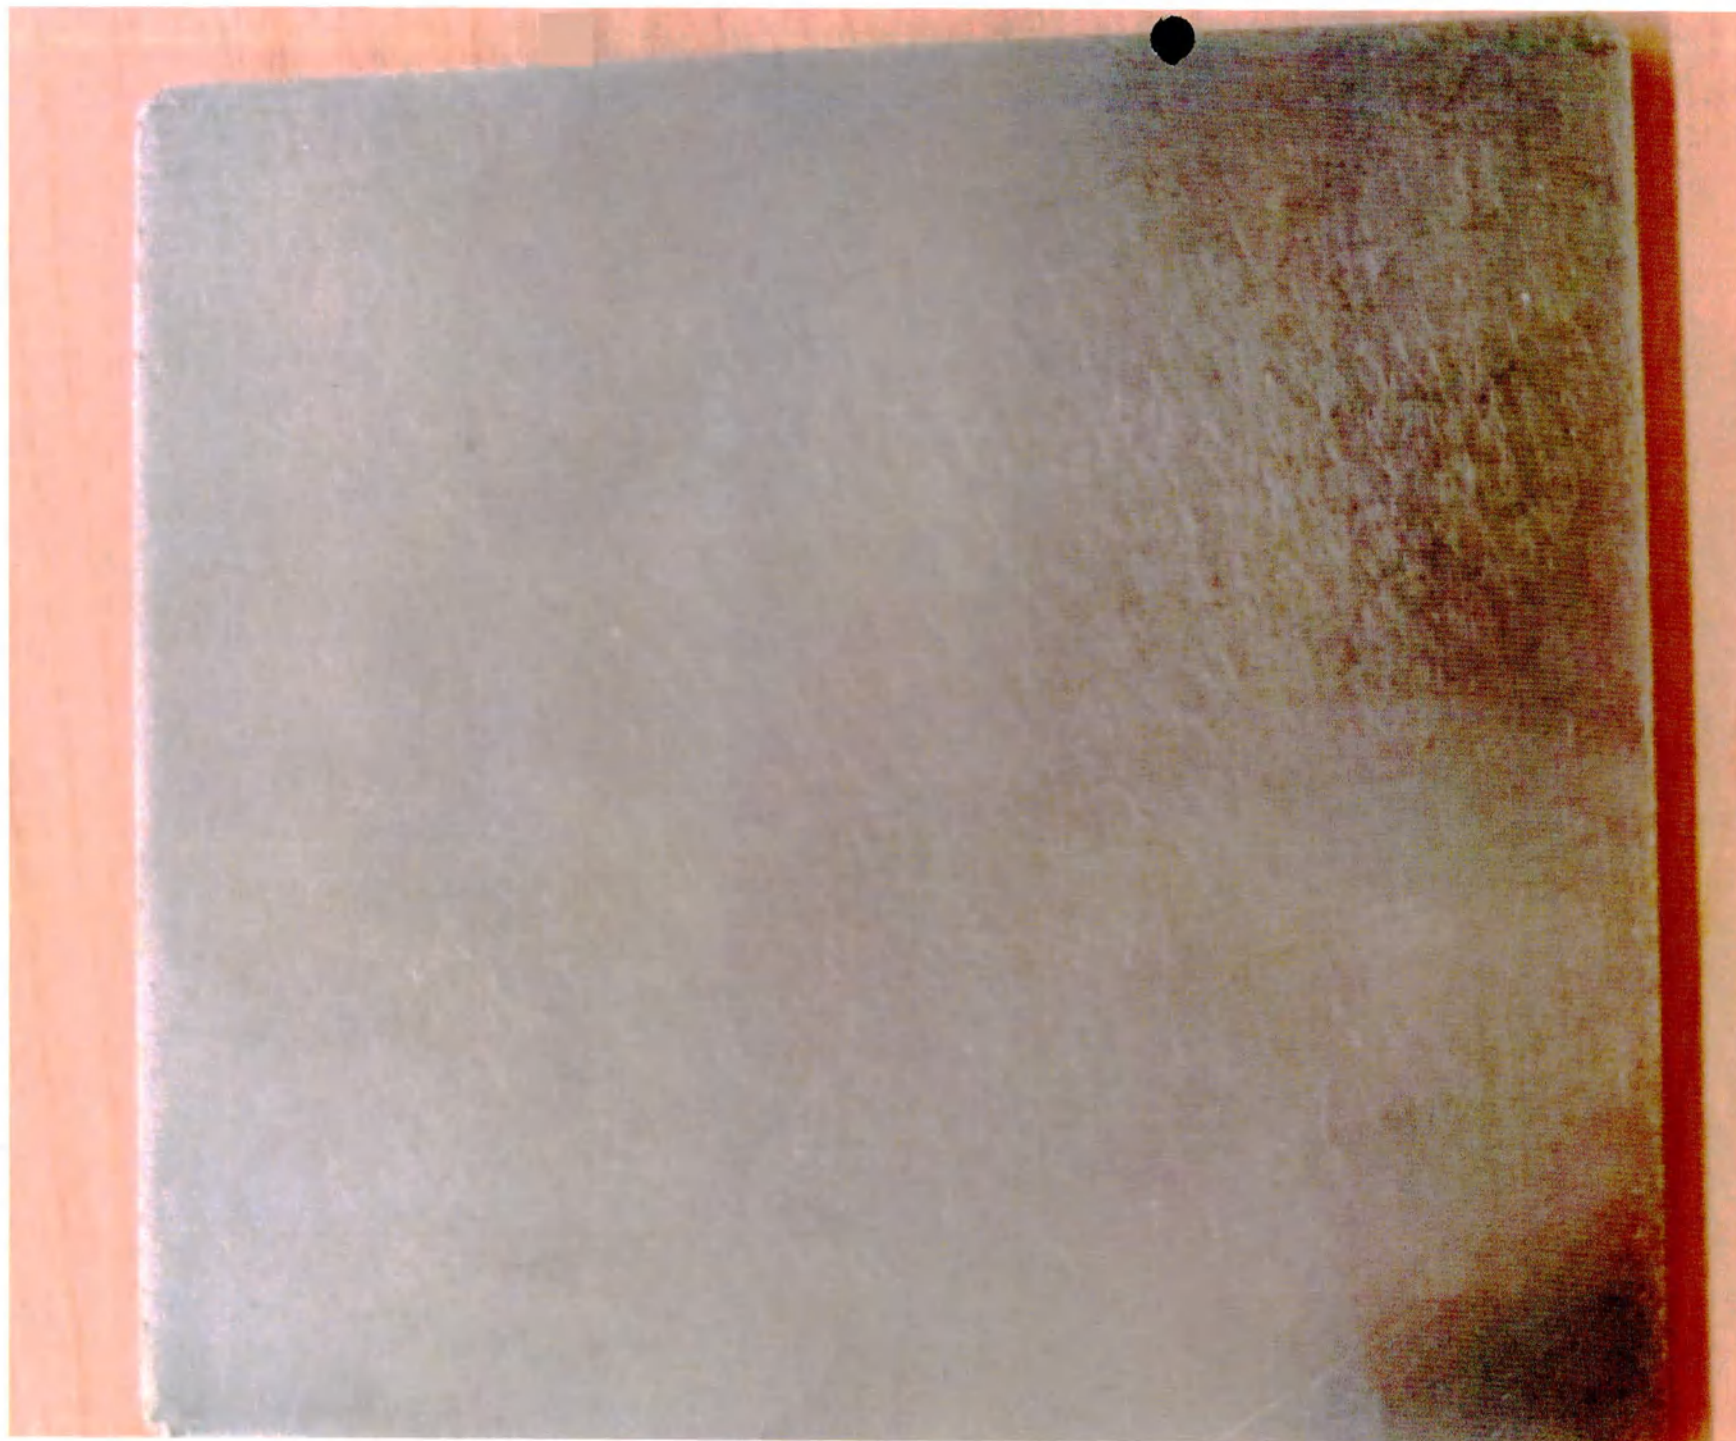

4.6 Опорная пластина

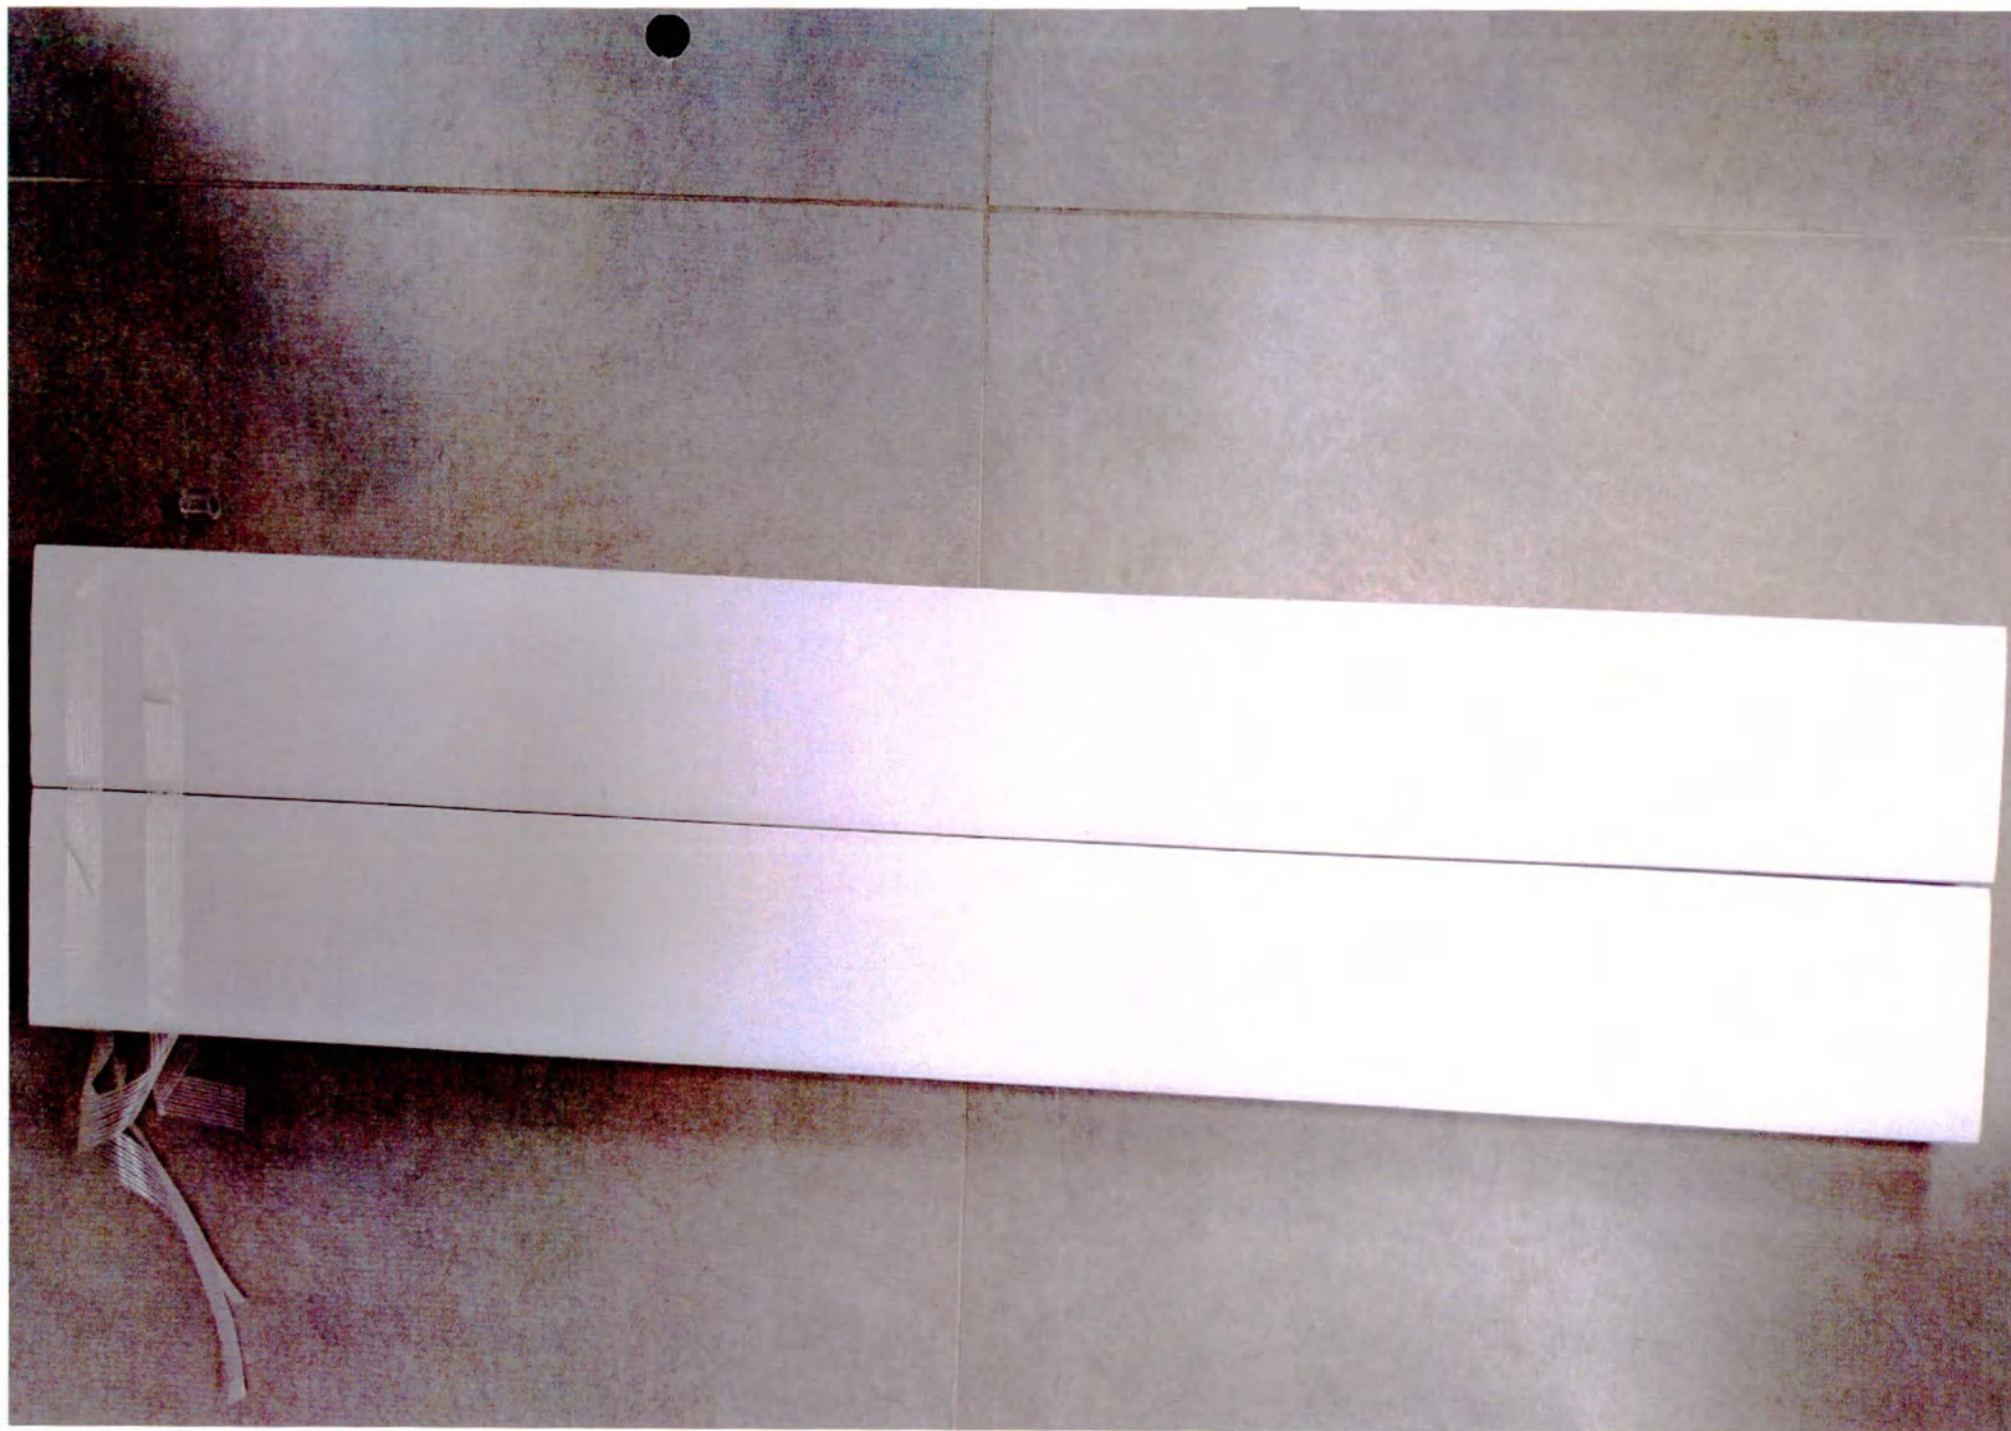


4.7 Короб для проводов (1,025 м)




5. Модуль «Sample Transmission Unit» L1




5.1 Кабель LAN сетевой 5 м

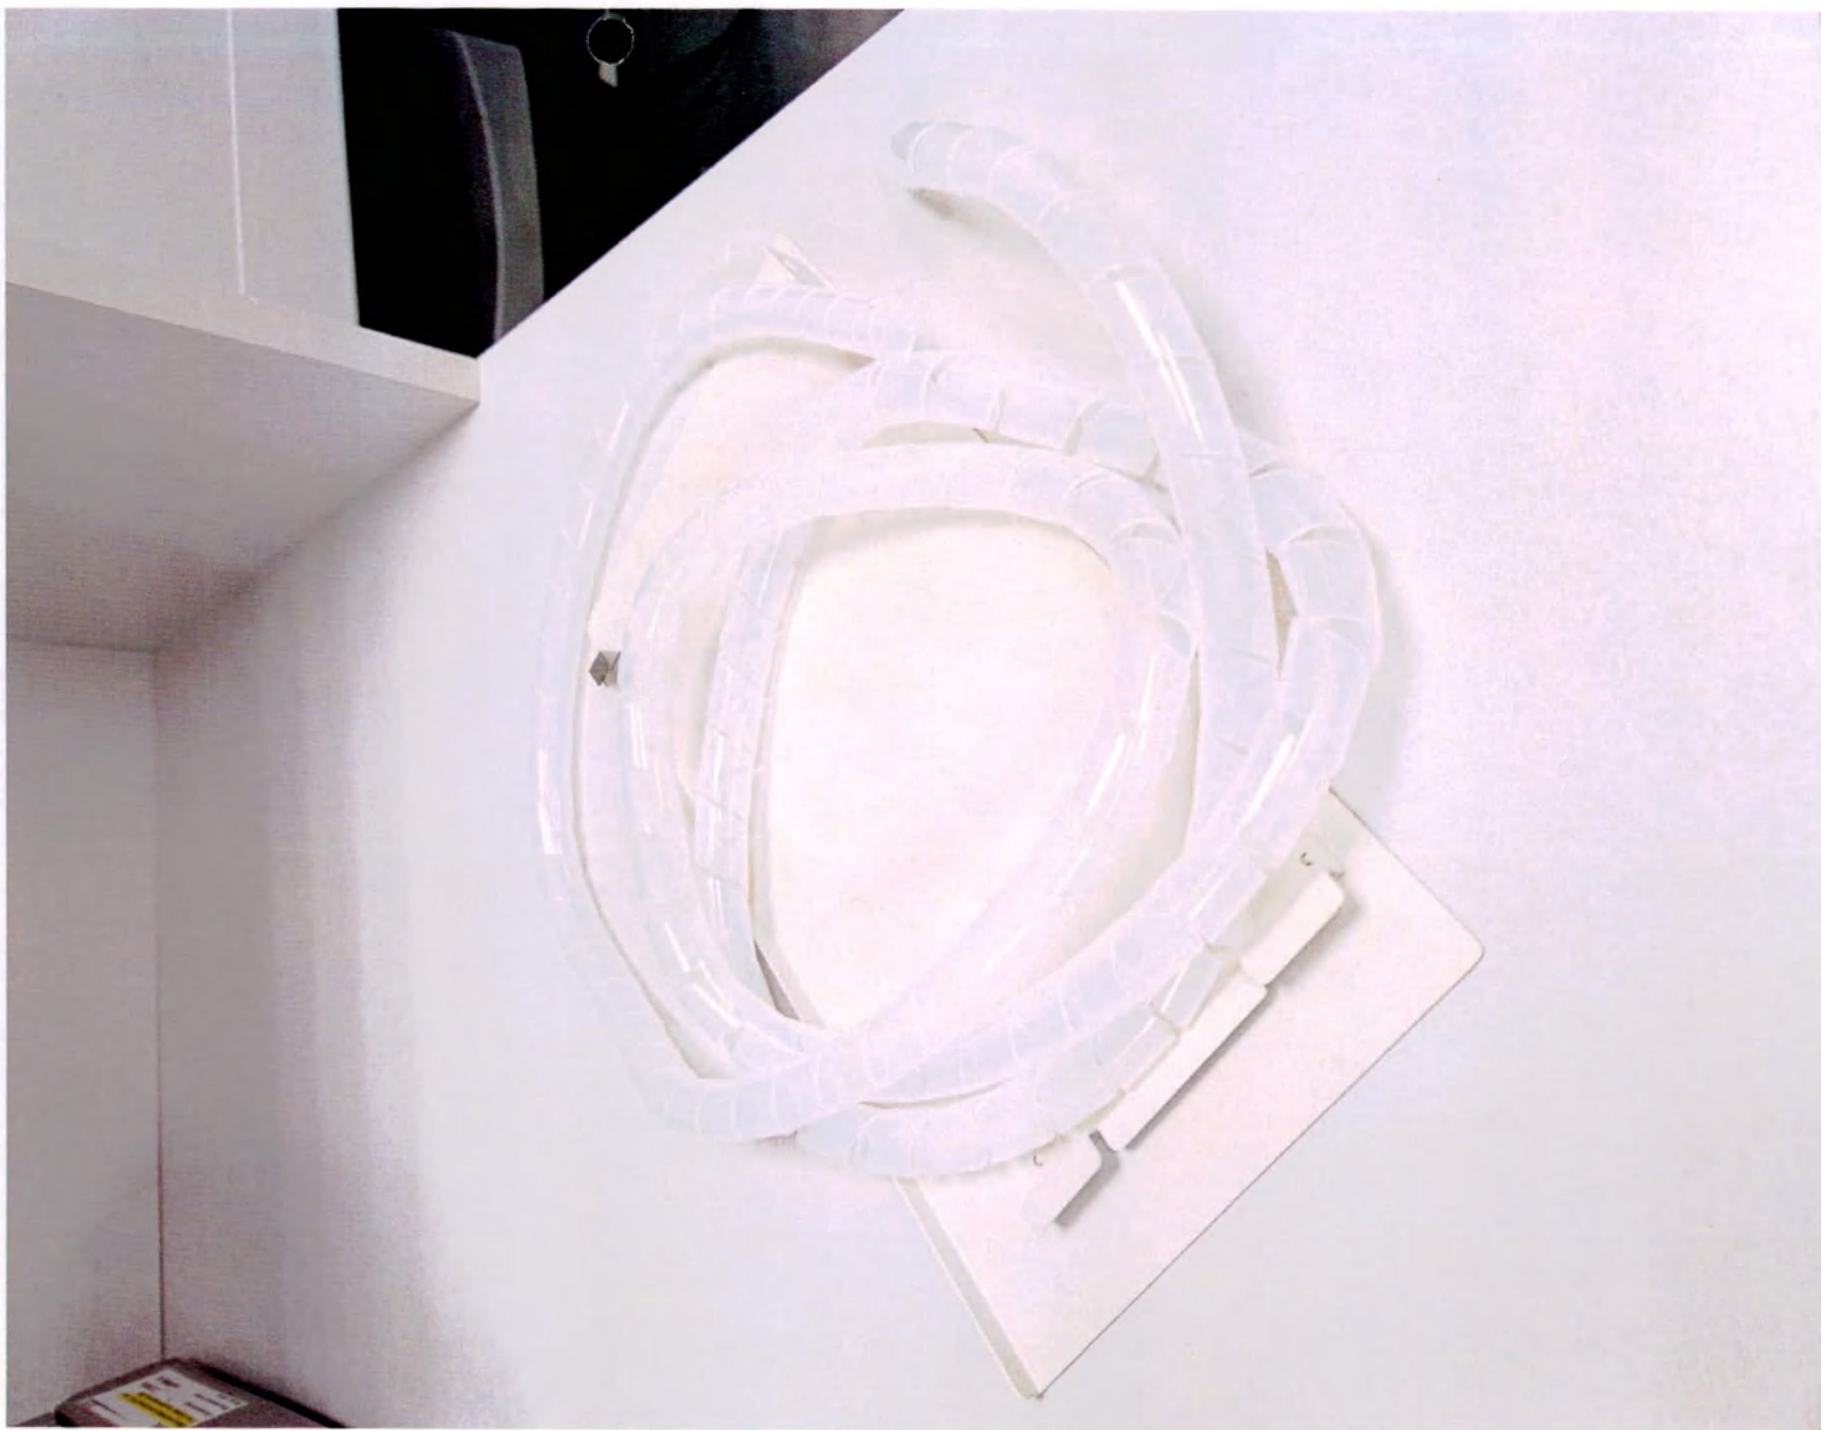

5.2 Лента крепёжная 2,0 м

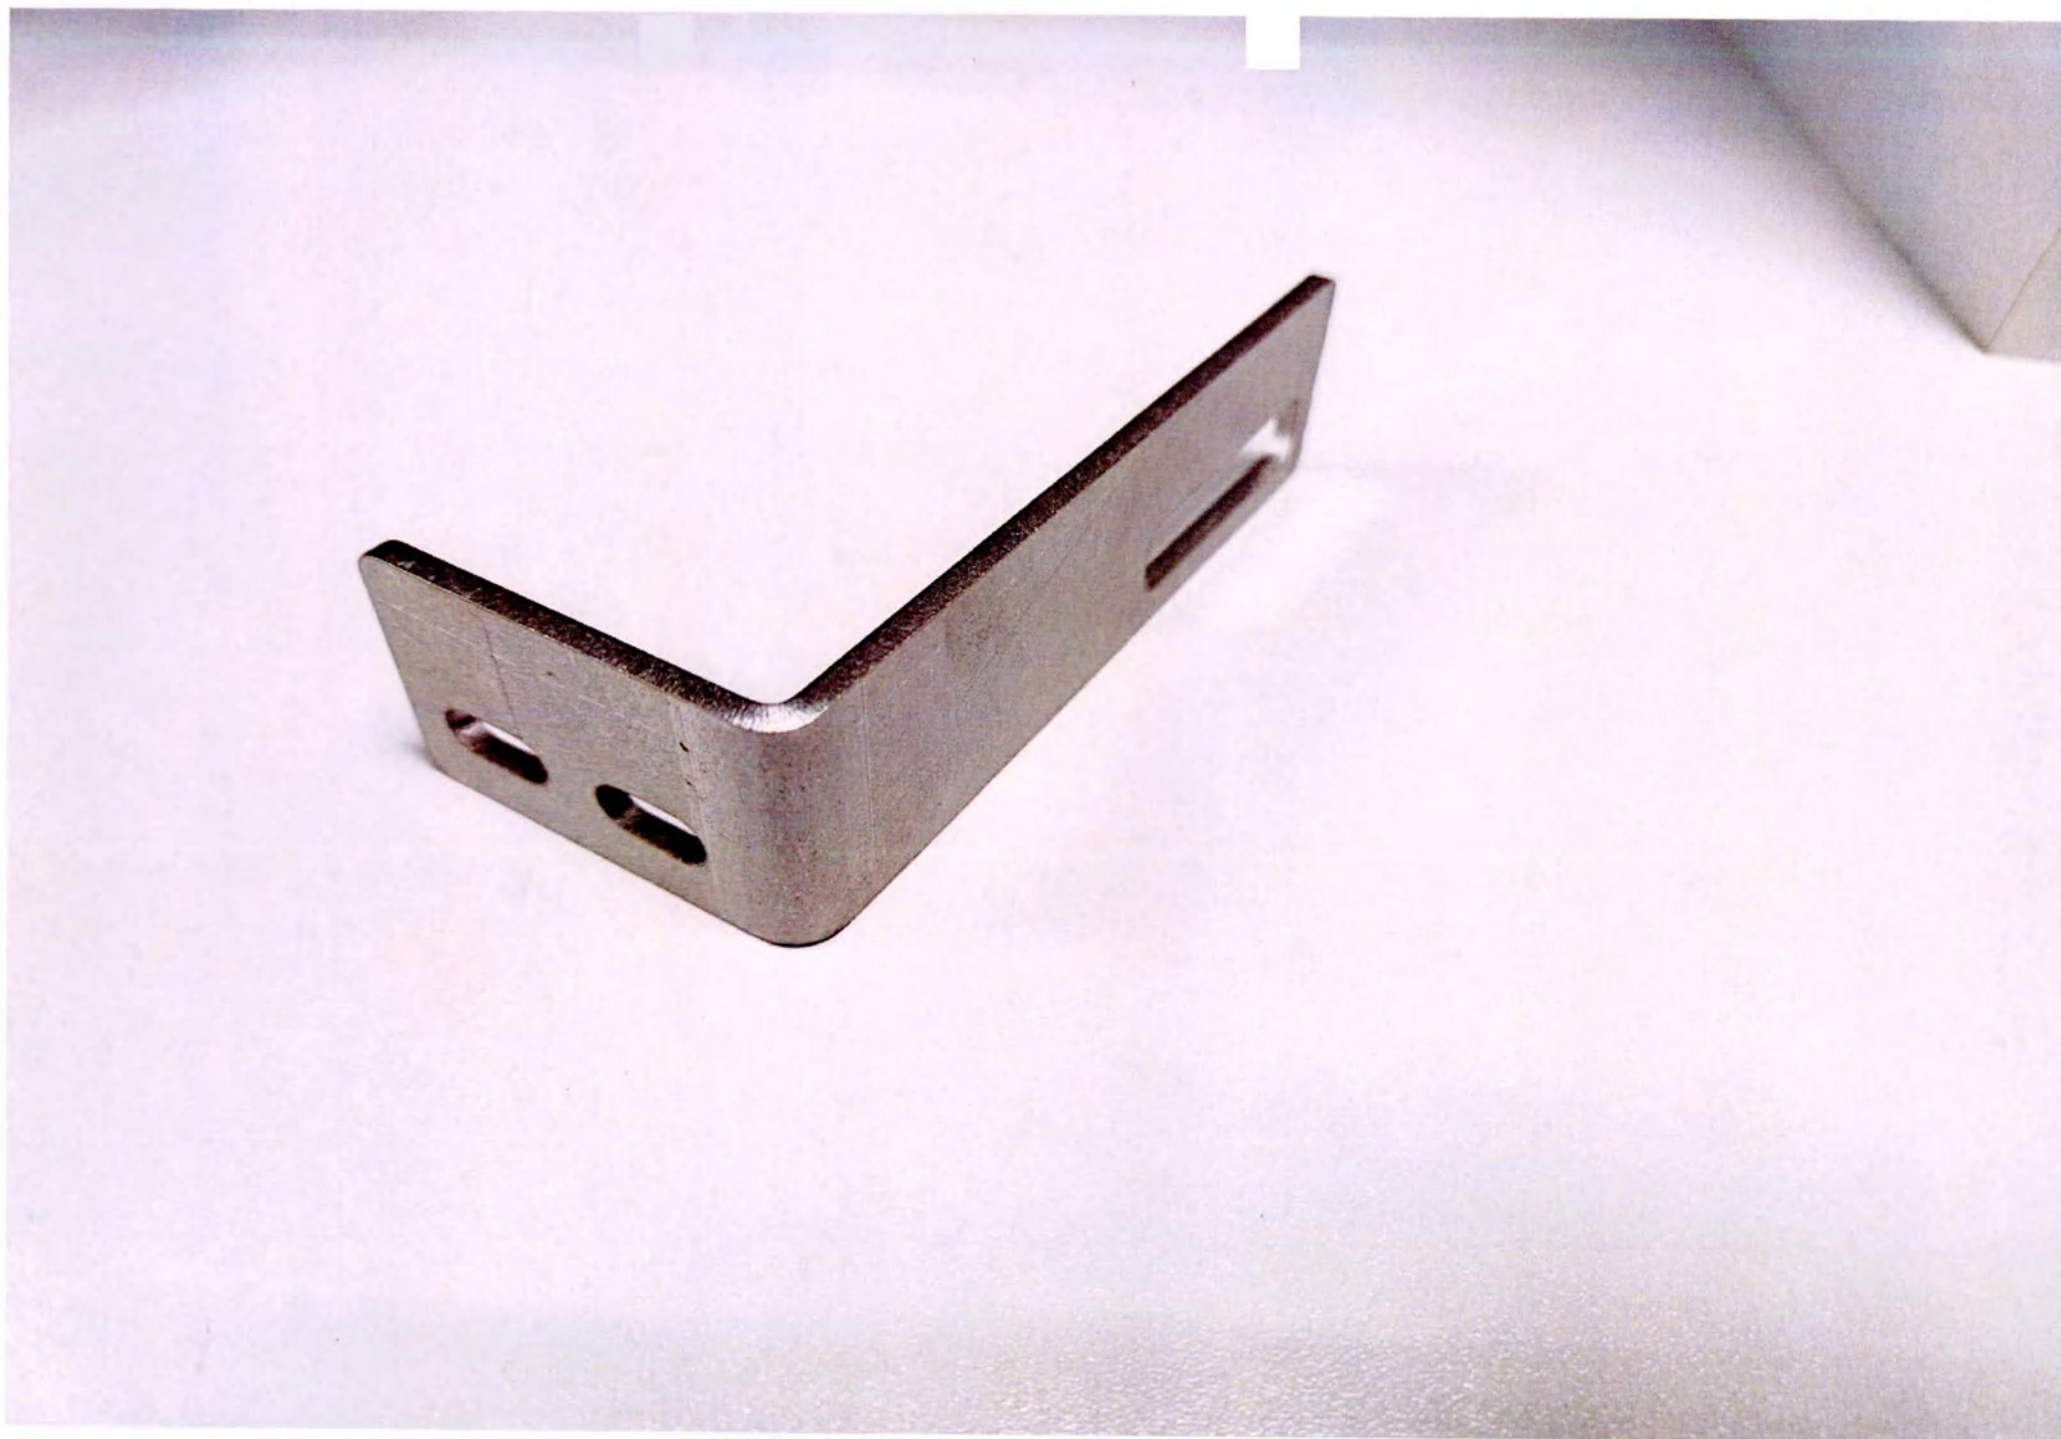


5.3 Вкладка крепёжная передняя

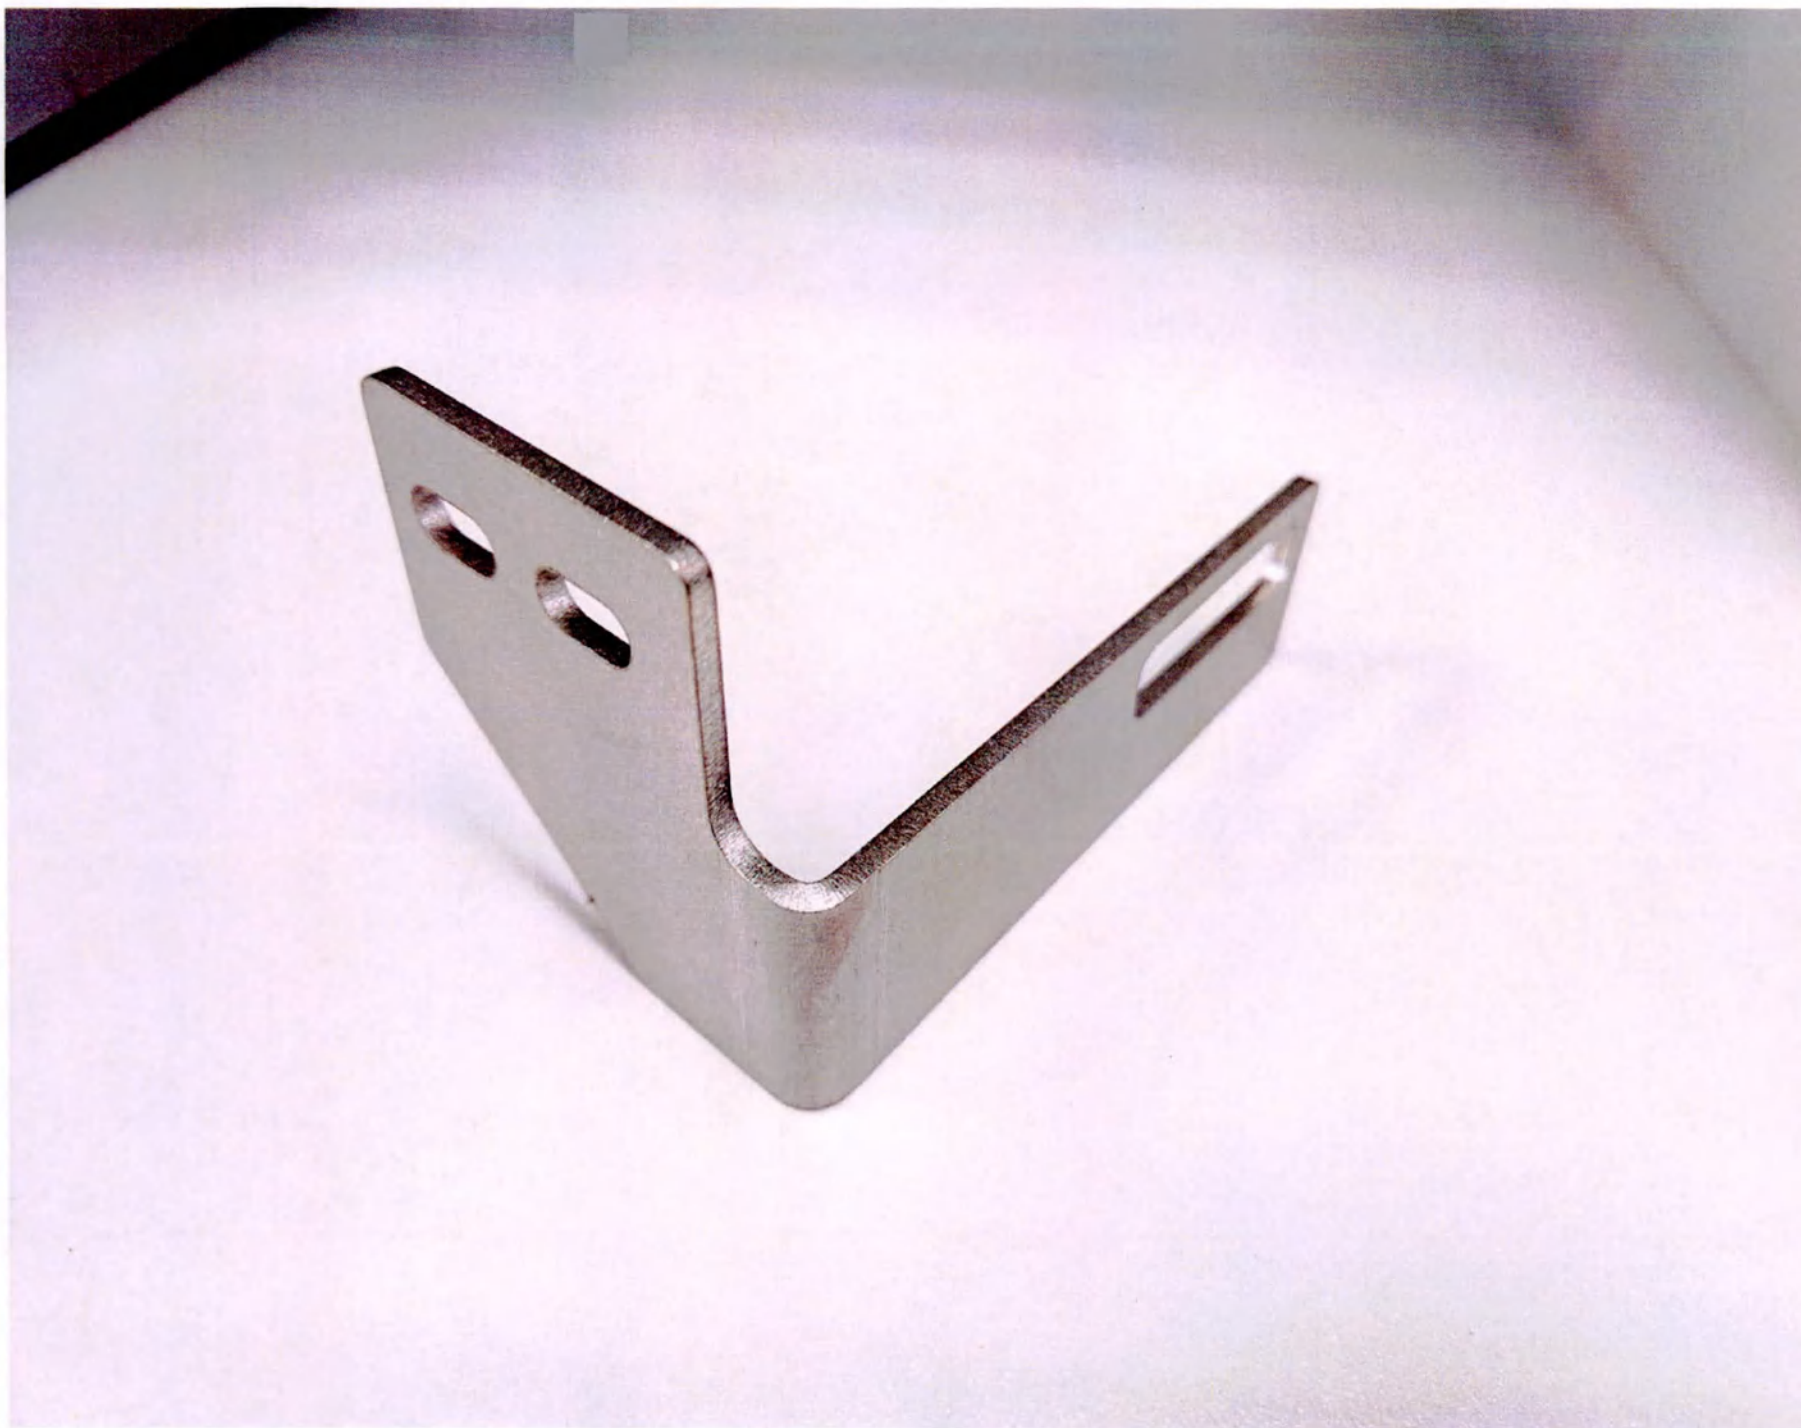

5.4 Вкладка крепёжная боковая




5.5 Опорная пластина

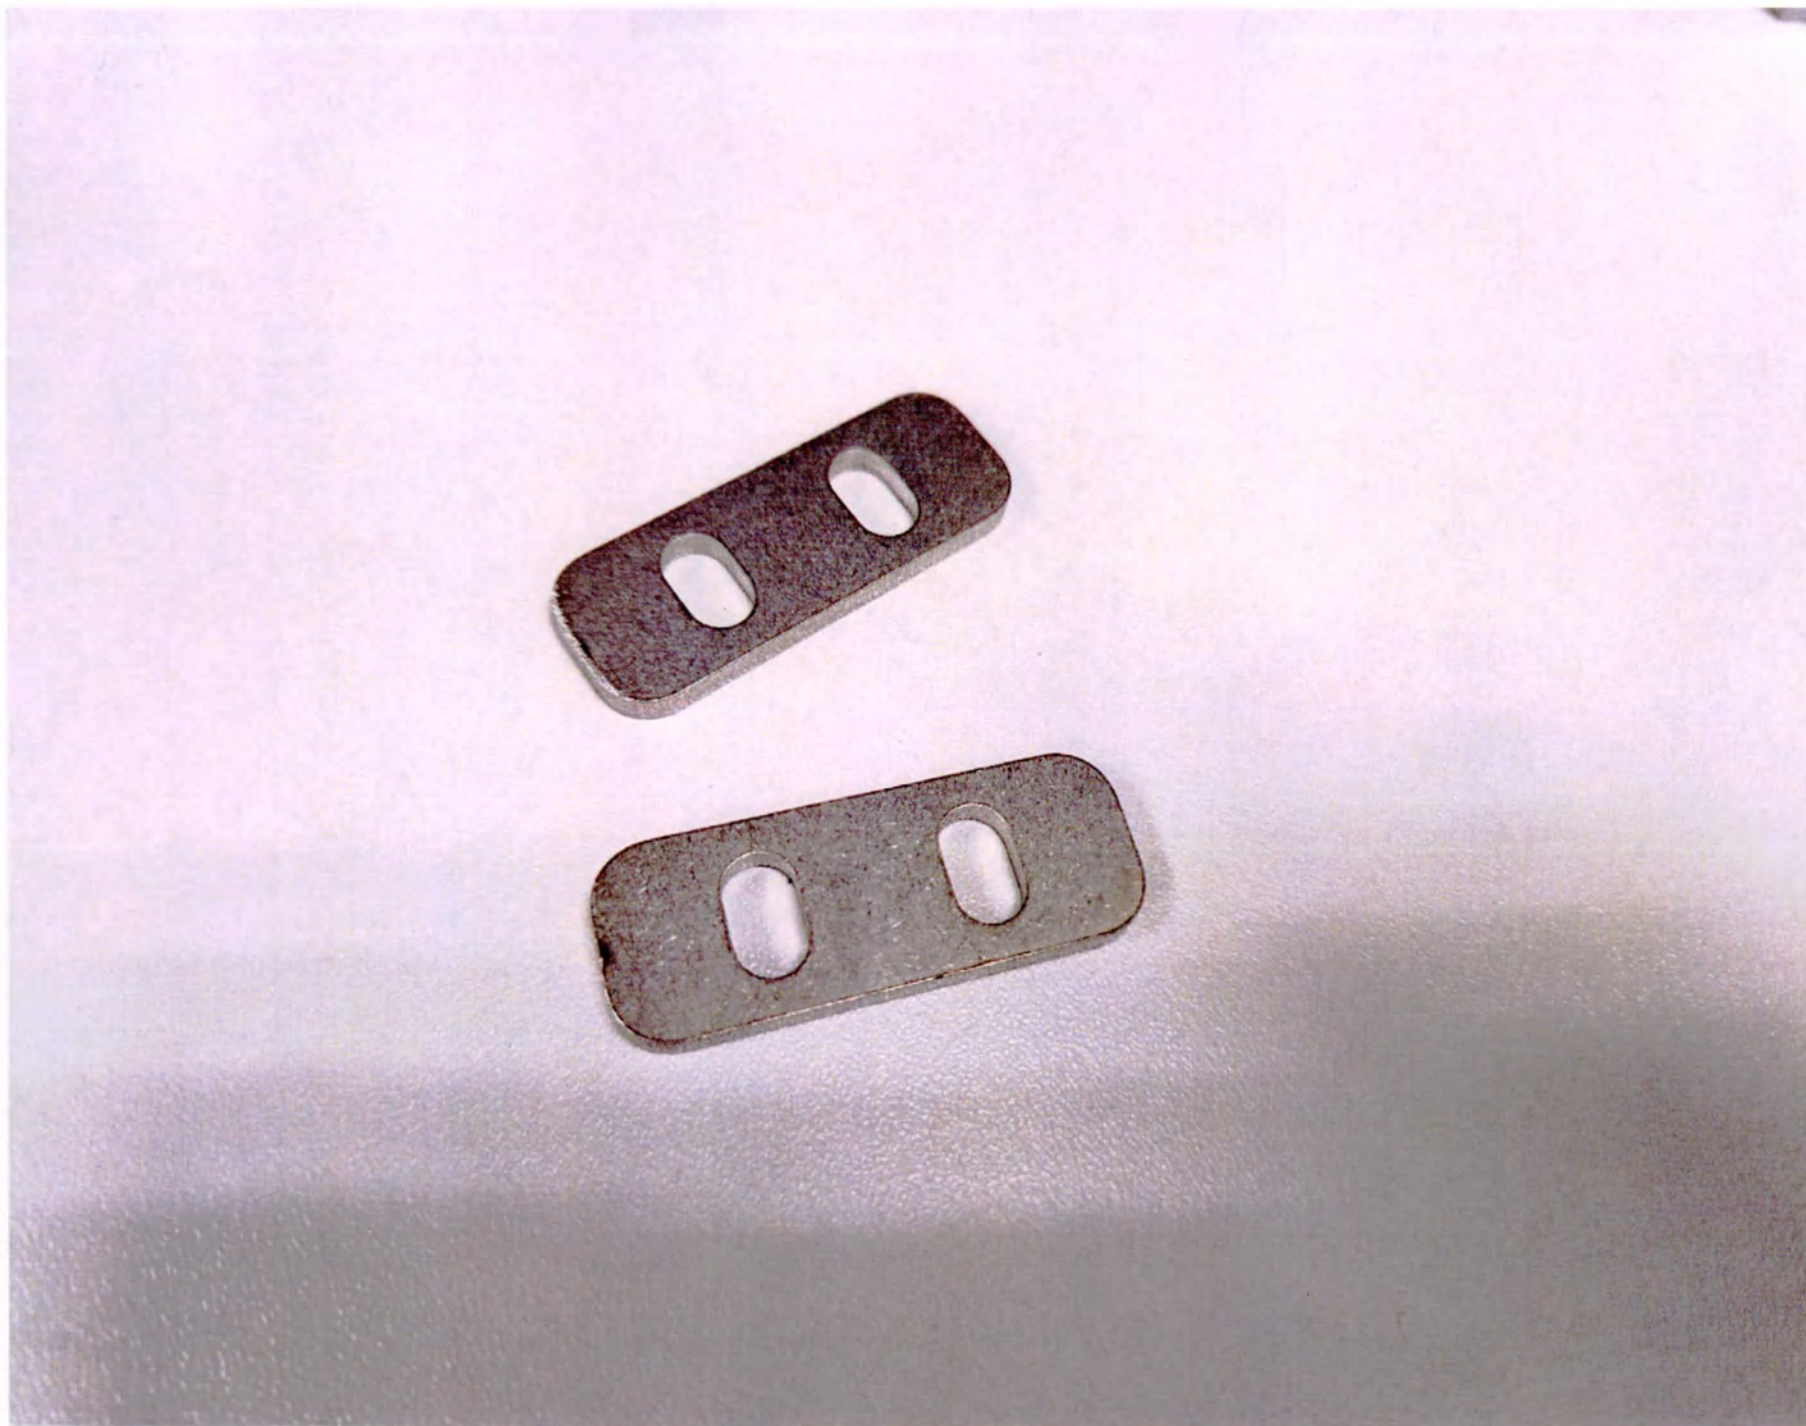


5.6 Вкладка фиксирующая



5.7 Панель декоративная 1

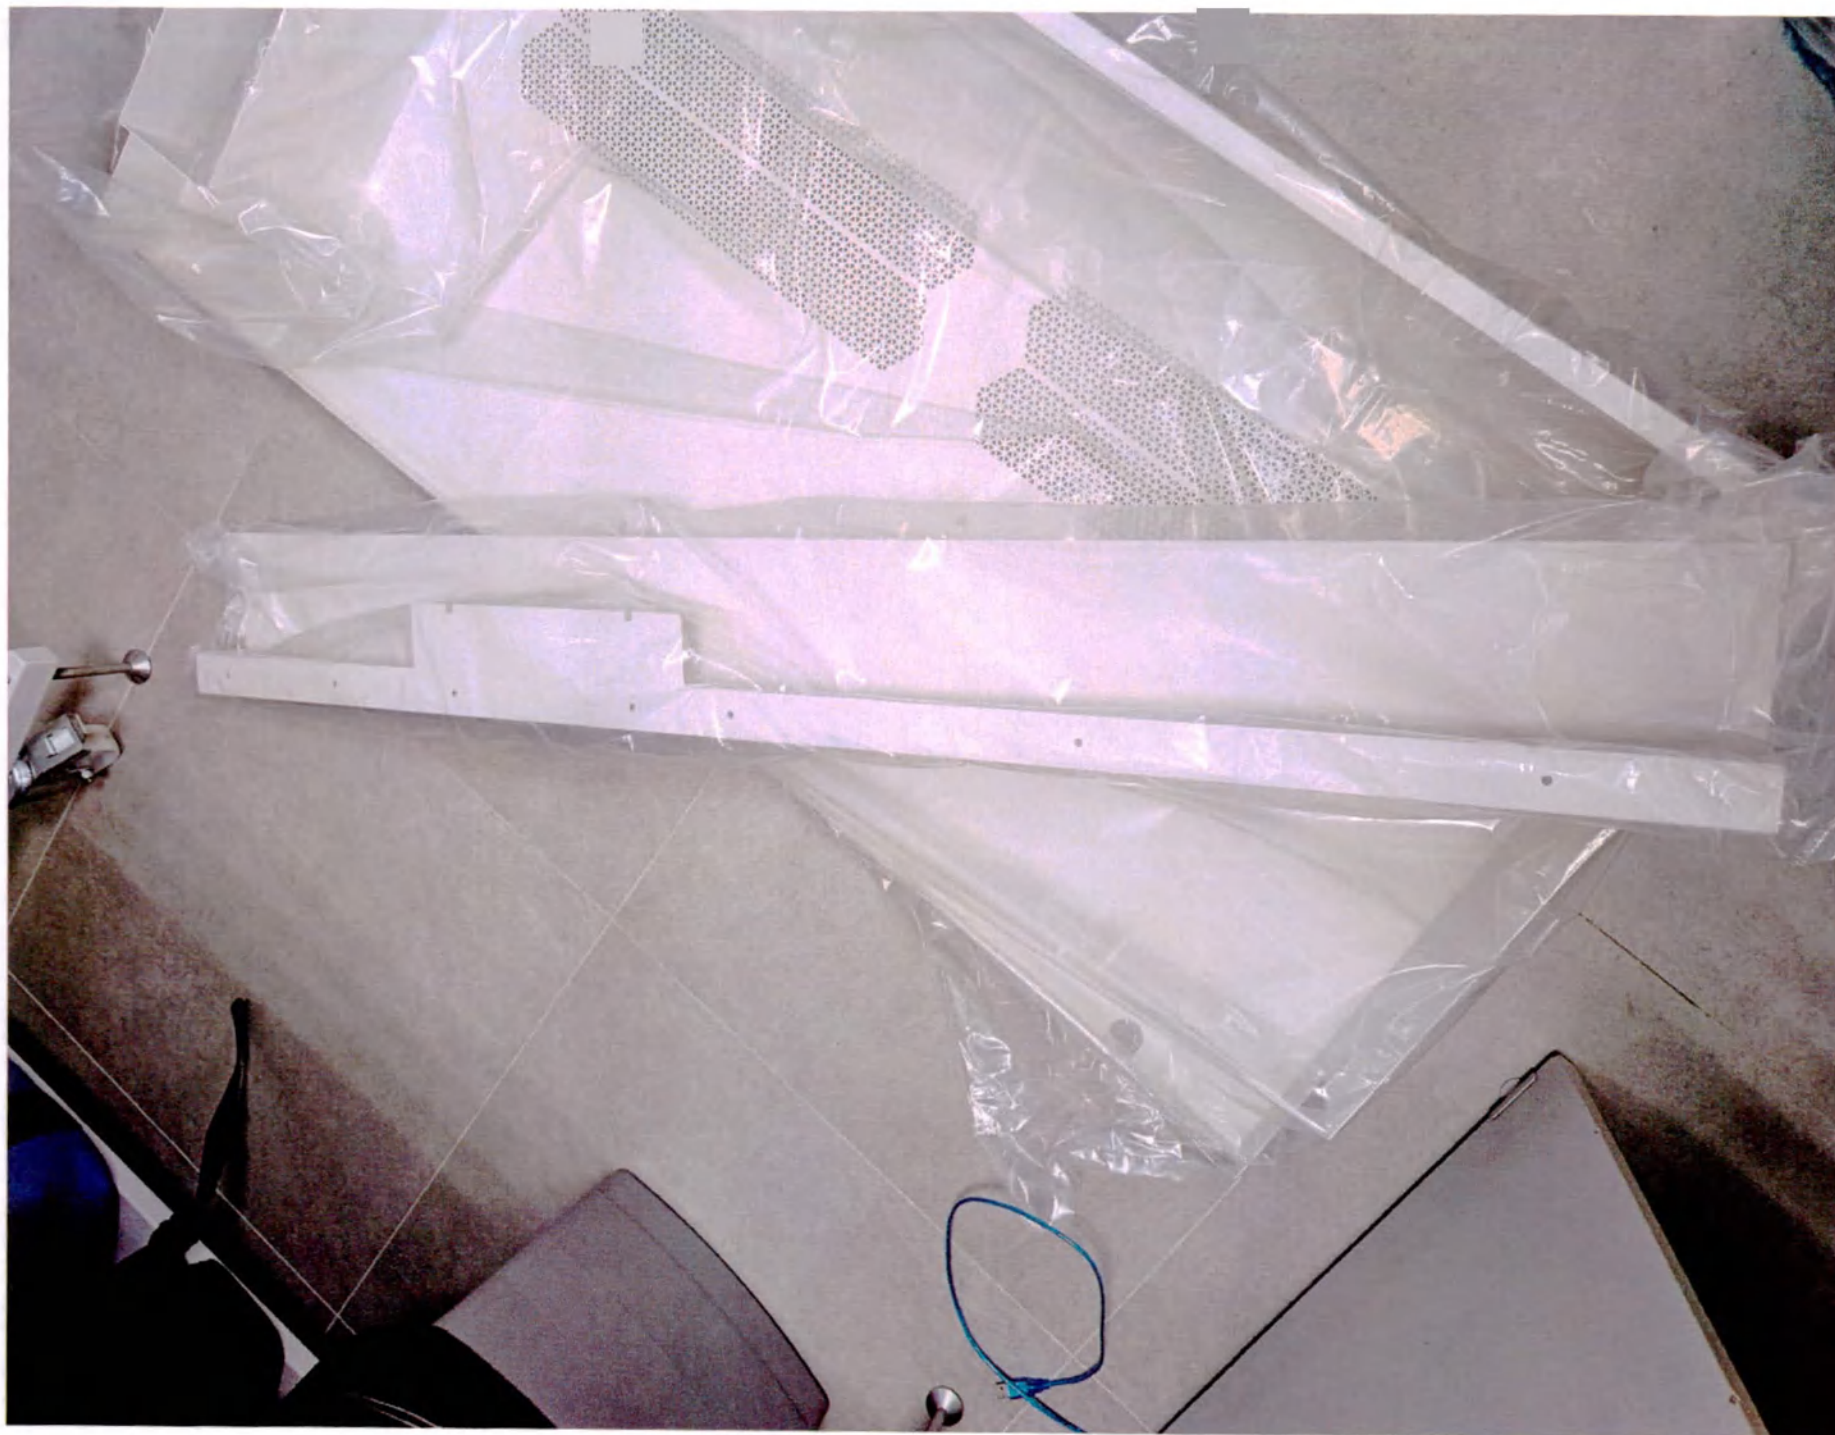

5.8 Панель декоративная 2

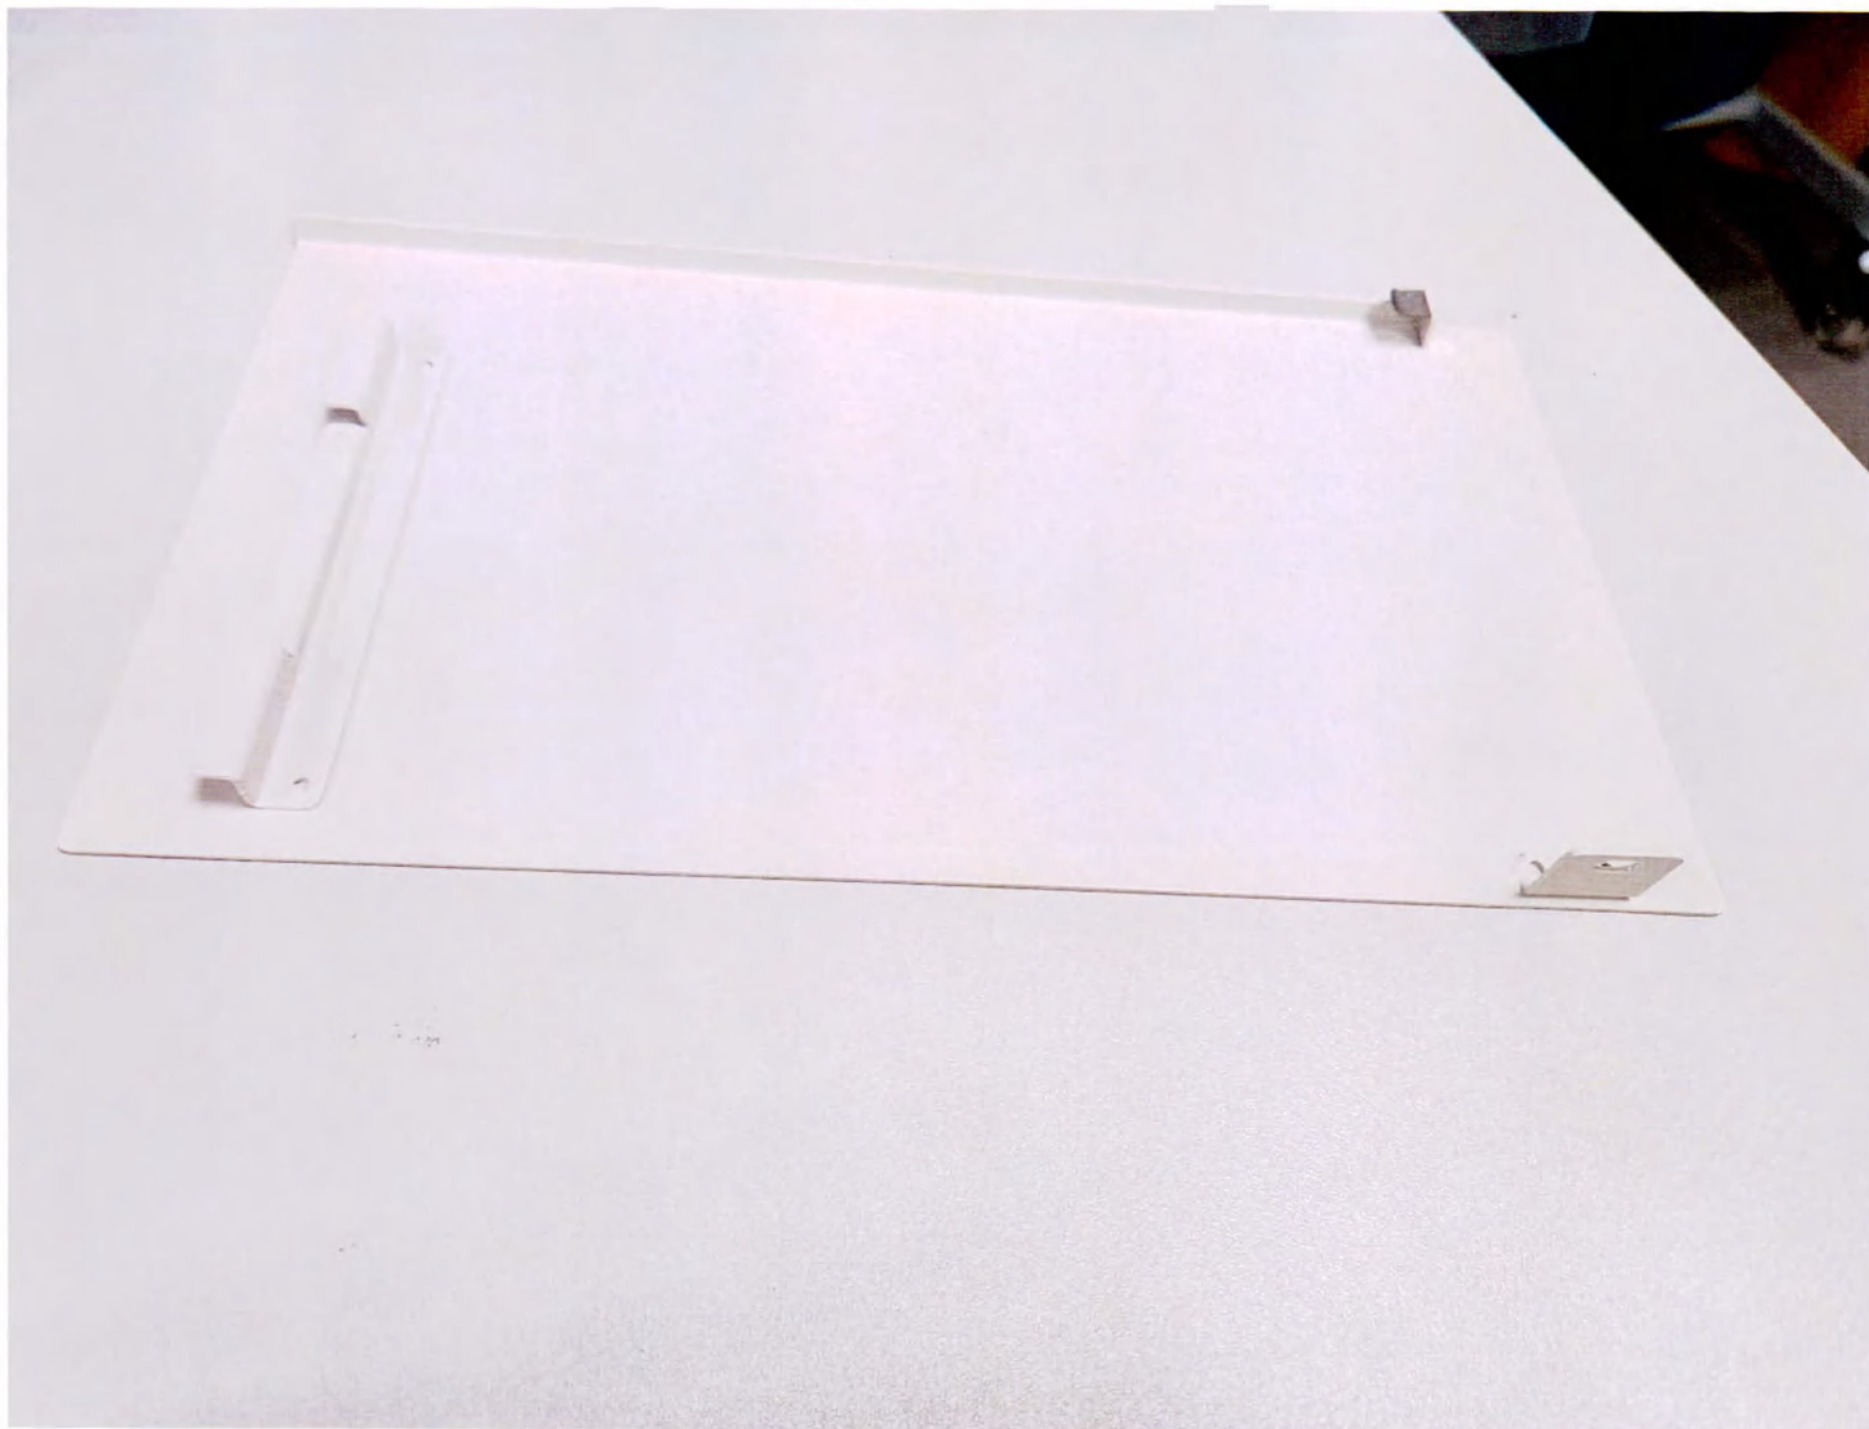

5.9 Панель концевая




6. Модуль «Sample Transmission Unit» L2




6.1 Кабель LAN сетевой 10м



6.2 Лента крепёжная 2,0 м

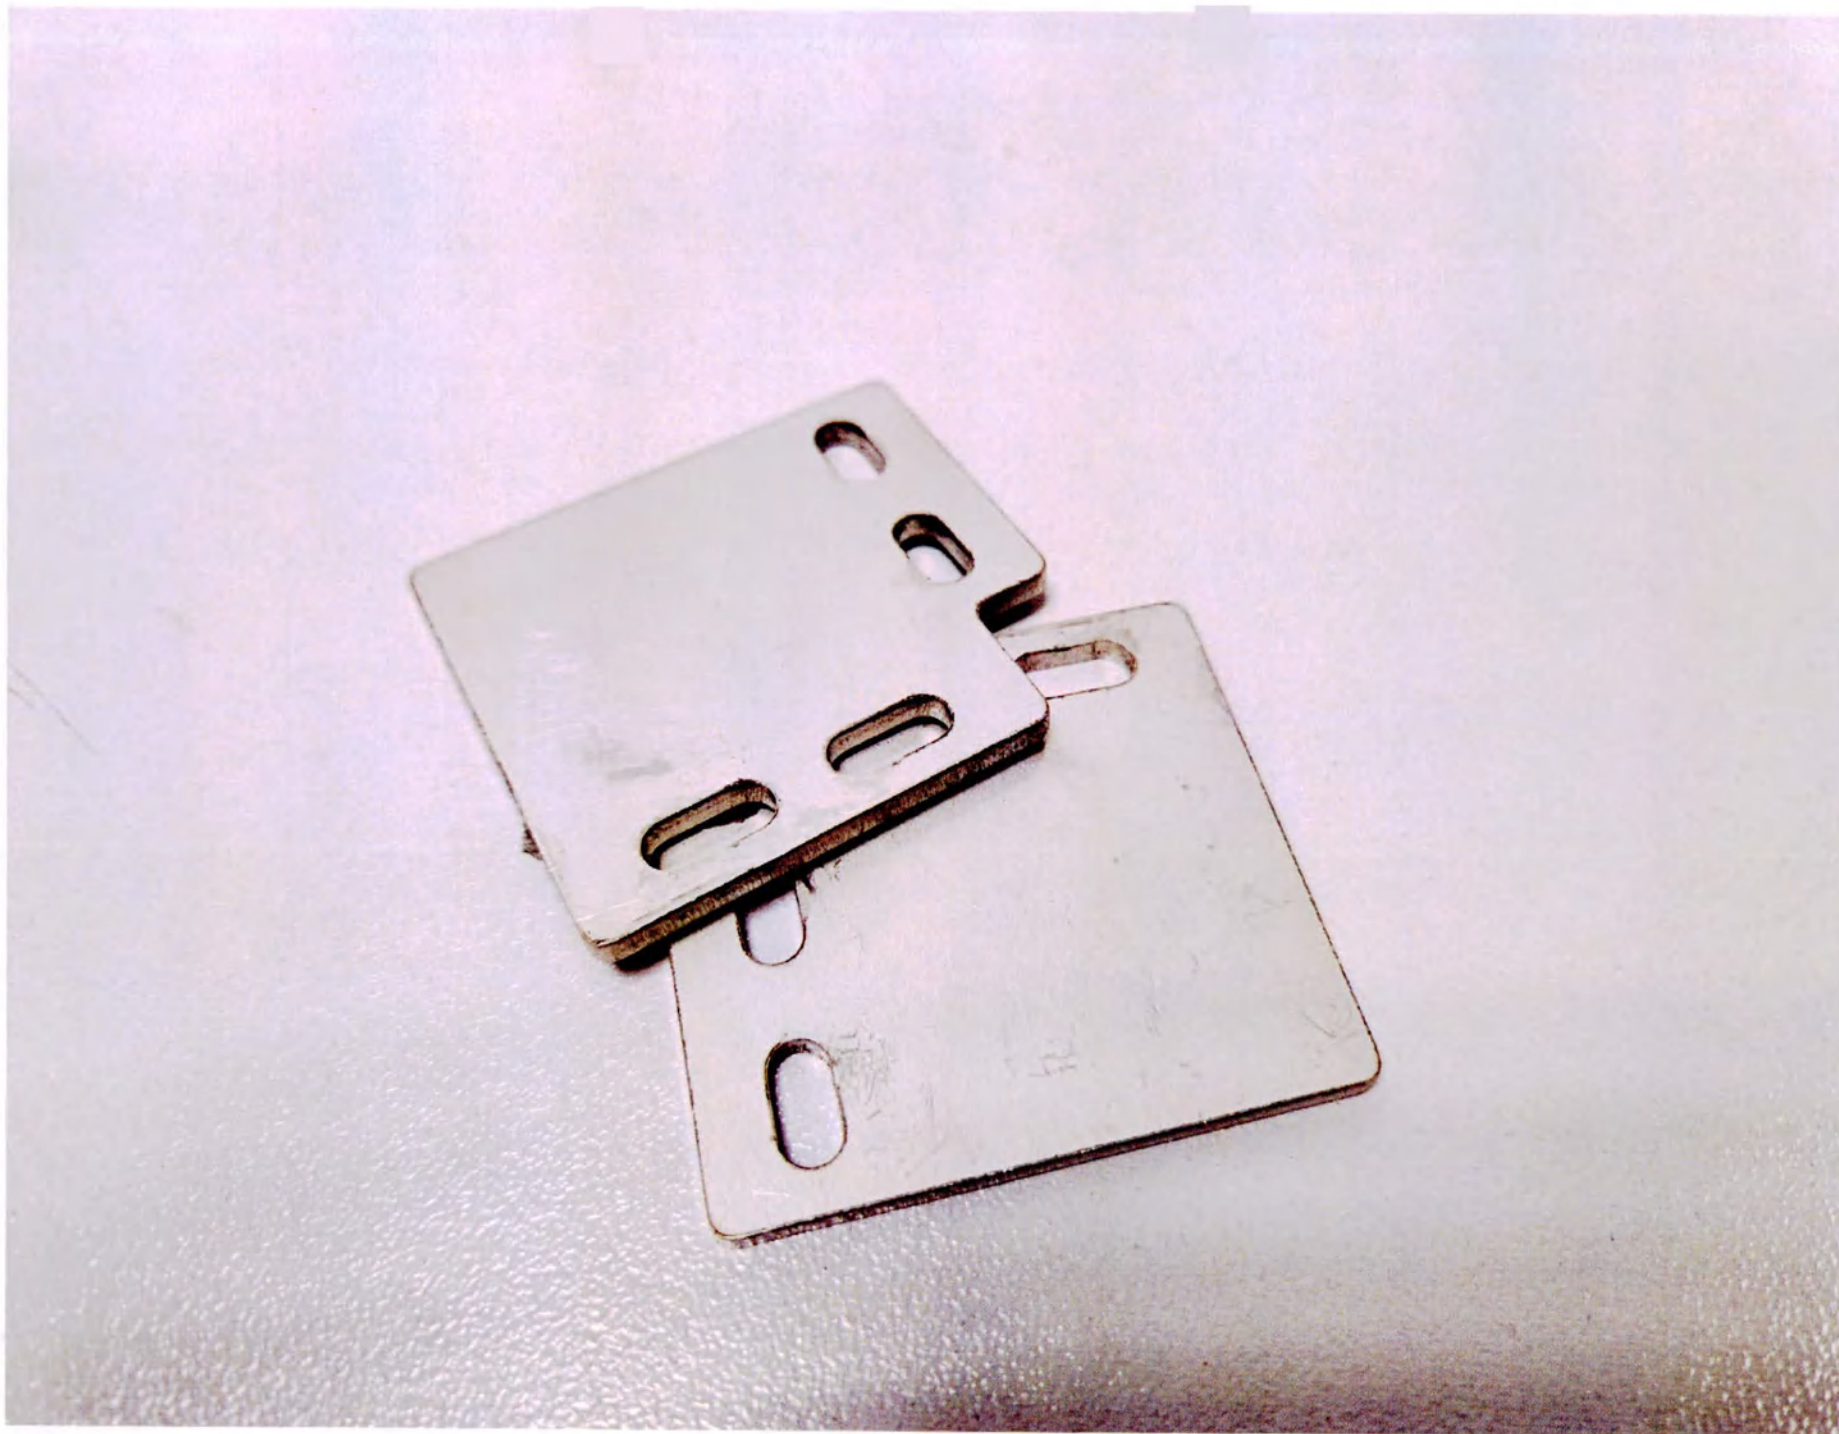

6.3 Анкерная пластина 2

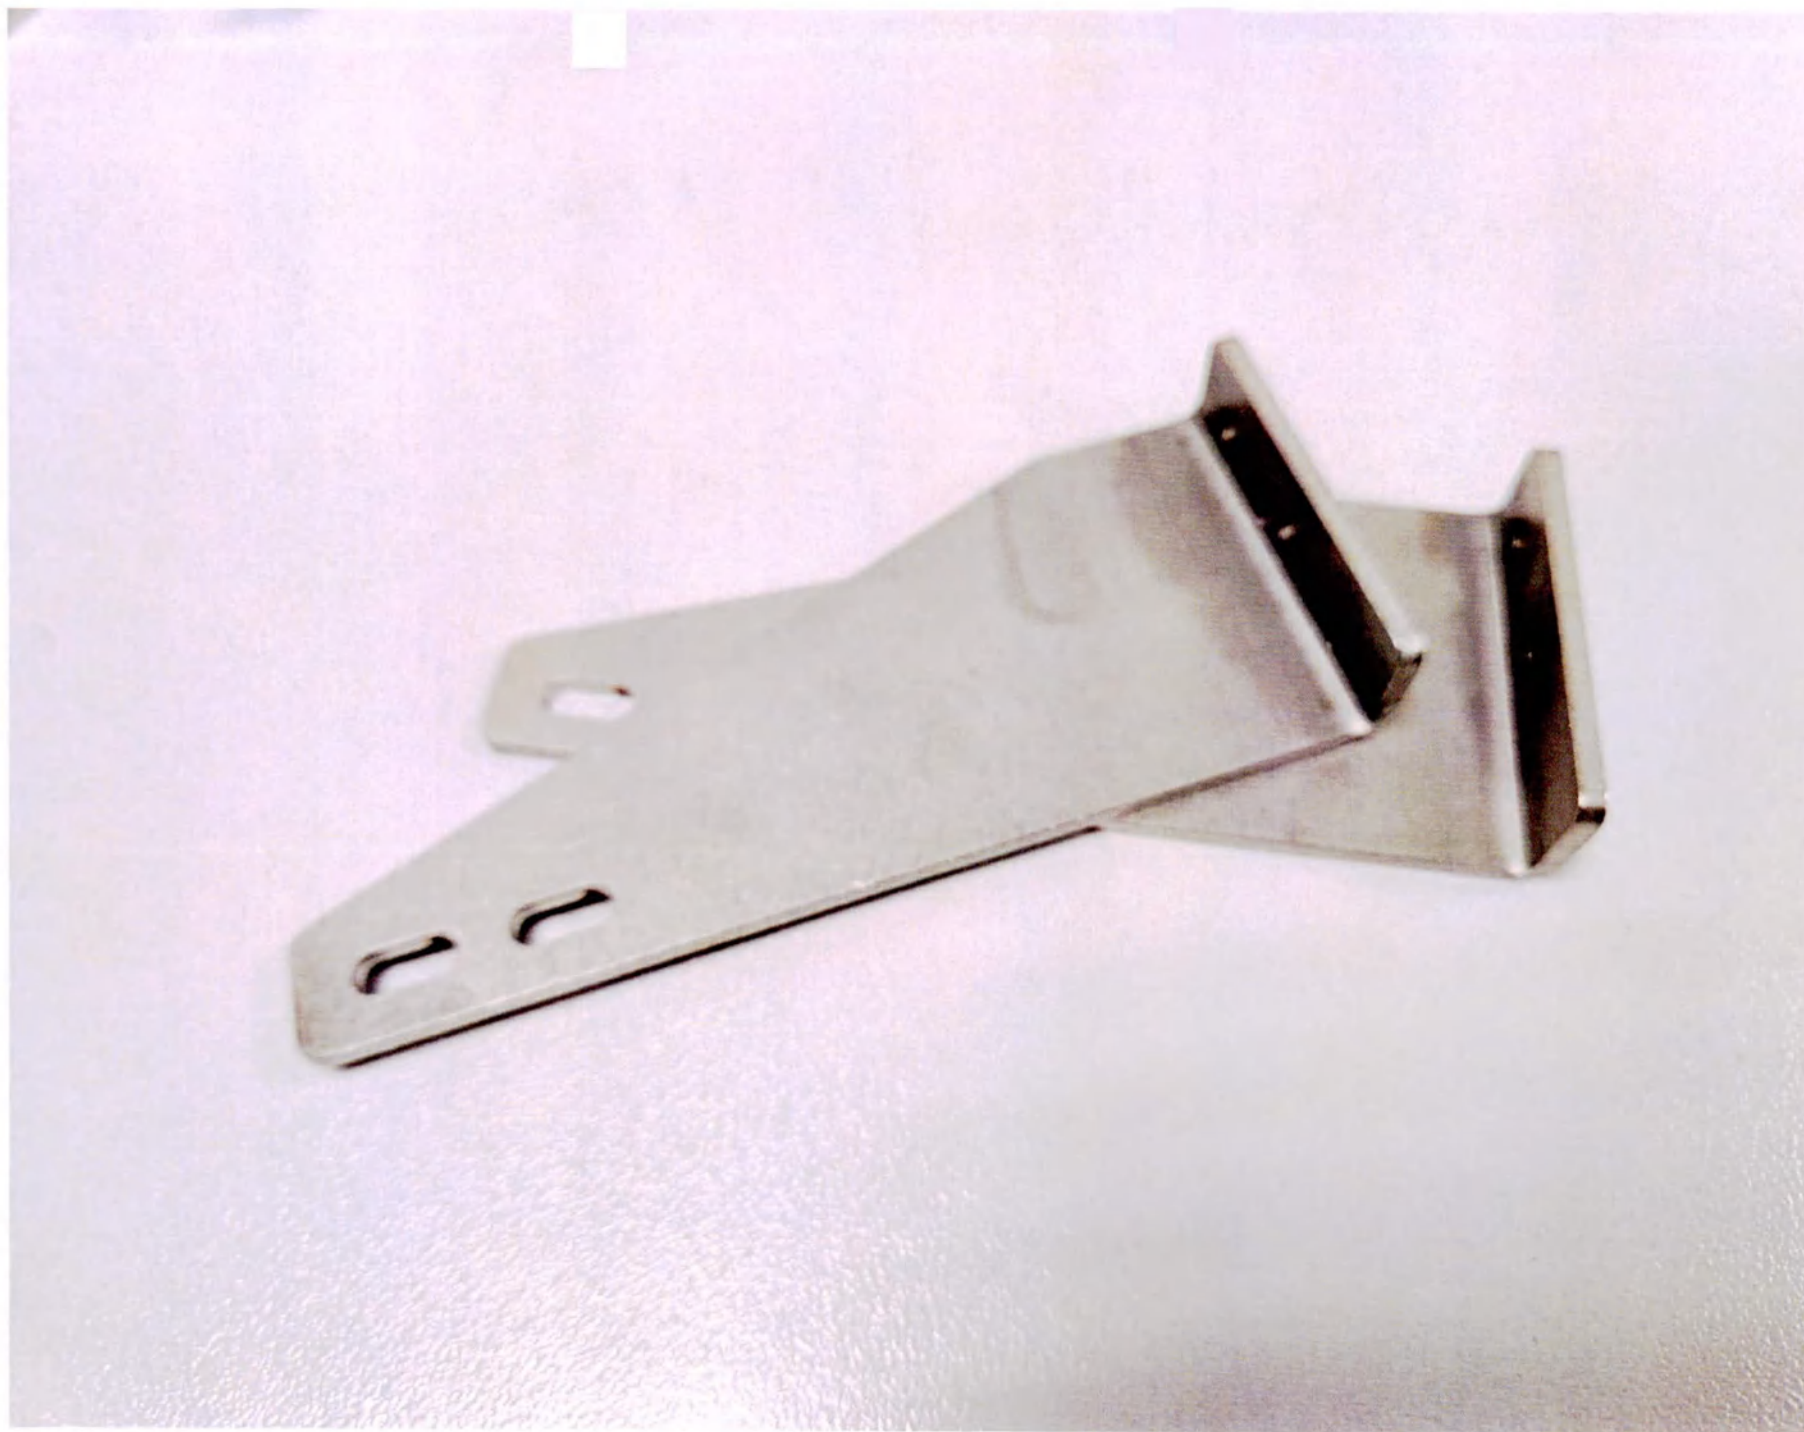


6.4 Анкерная пластина 4




6.5 Опорная пластина




6.6 Панель декоративная 1

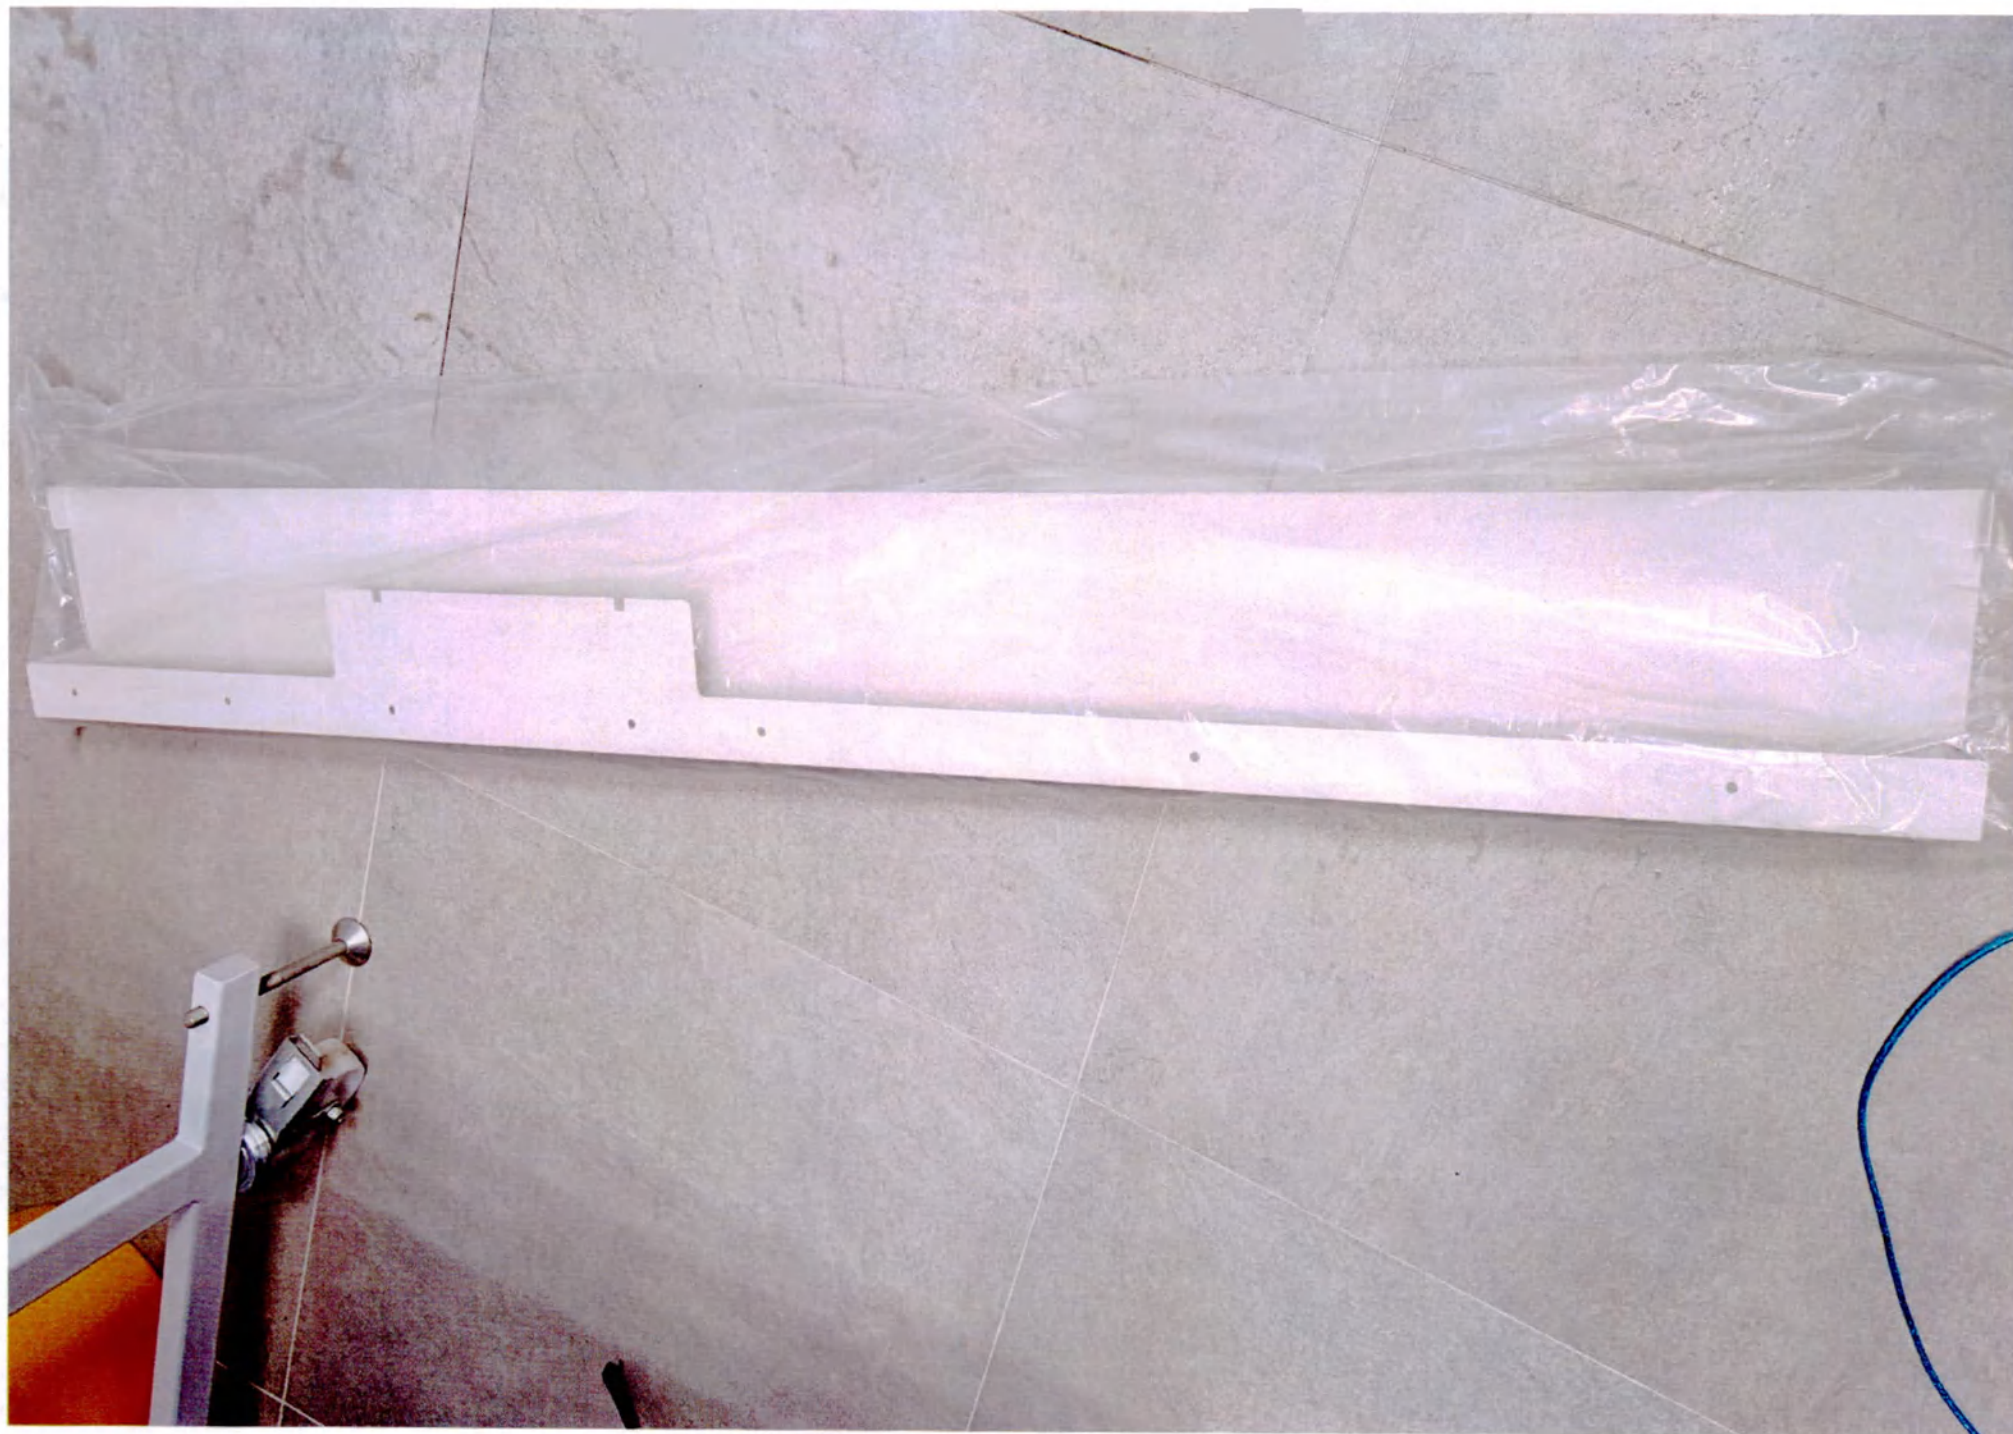


6.7 Панель декоративная 2

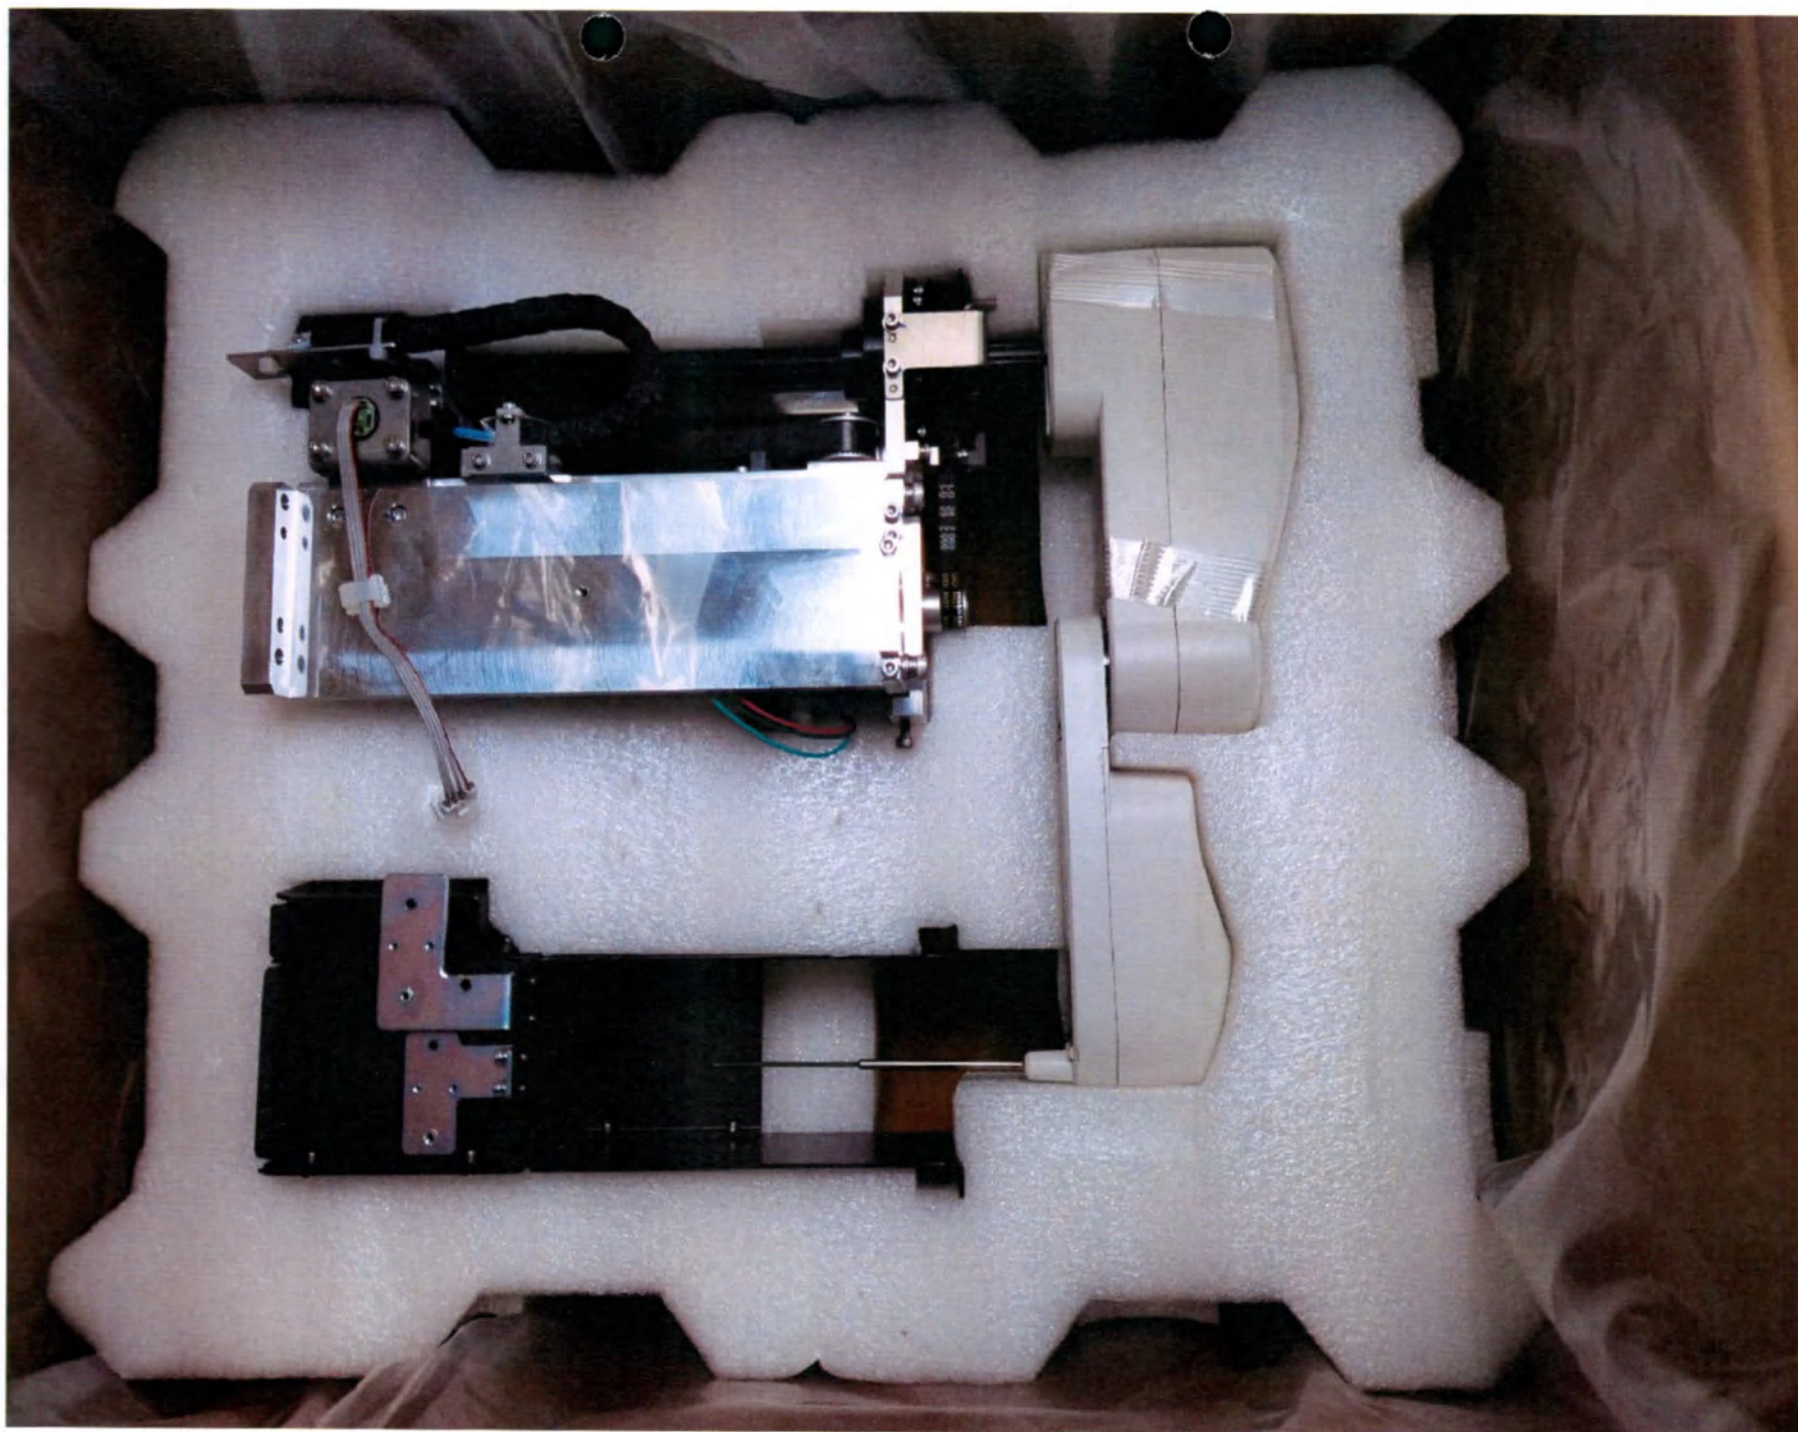


7. Пробозаборник для режима параллельной работы «SCARA»

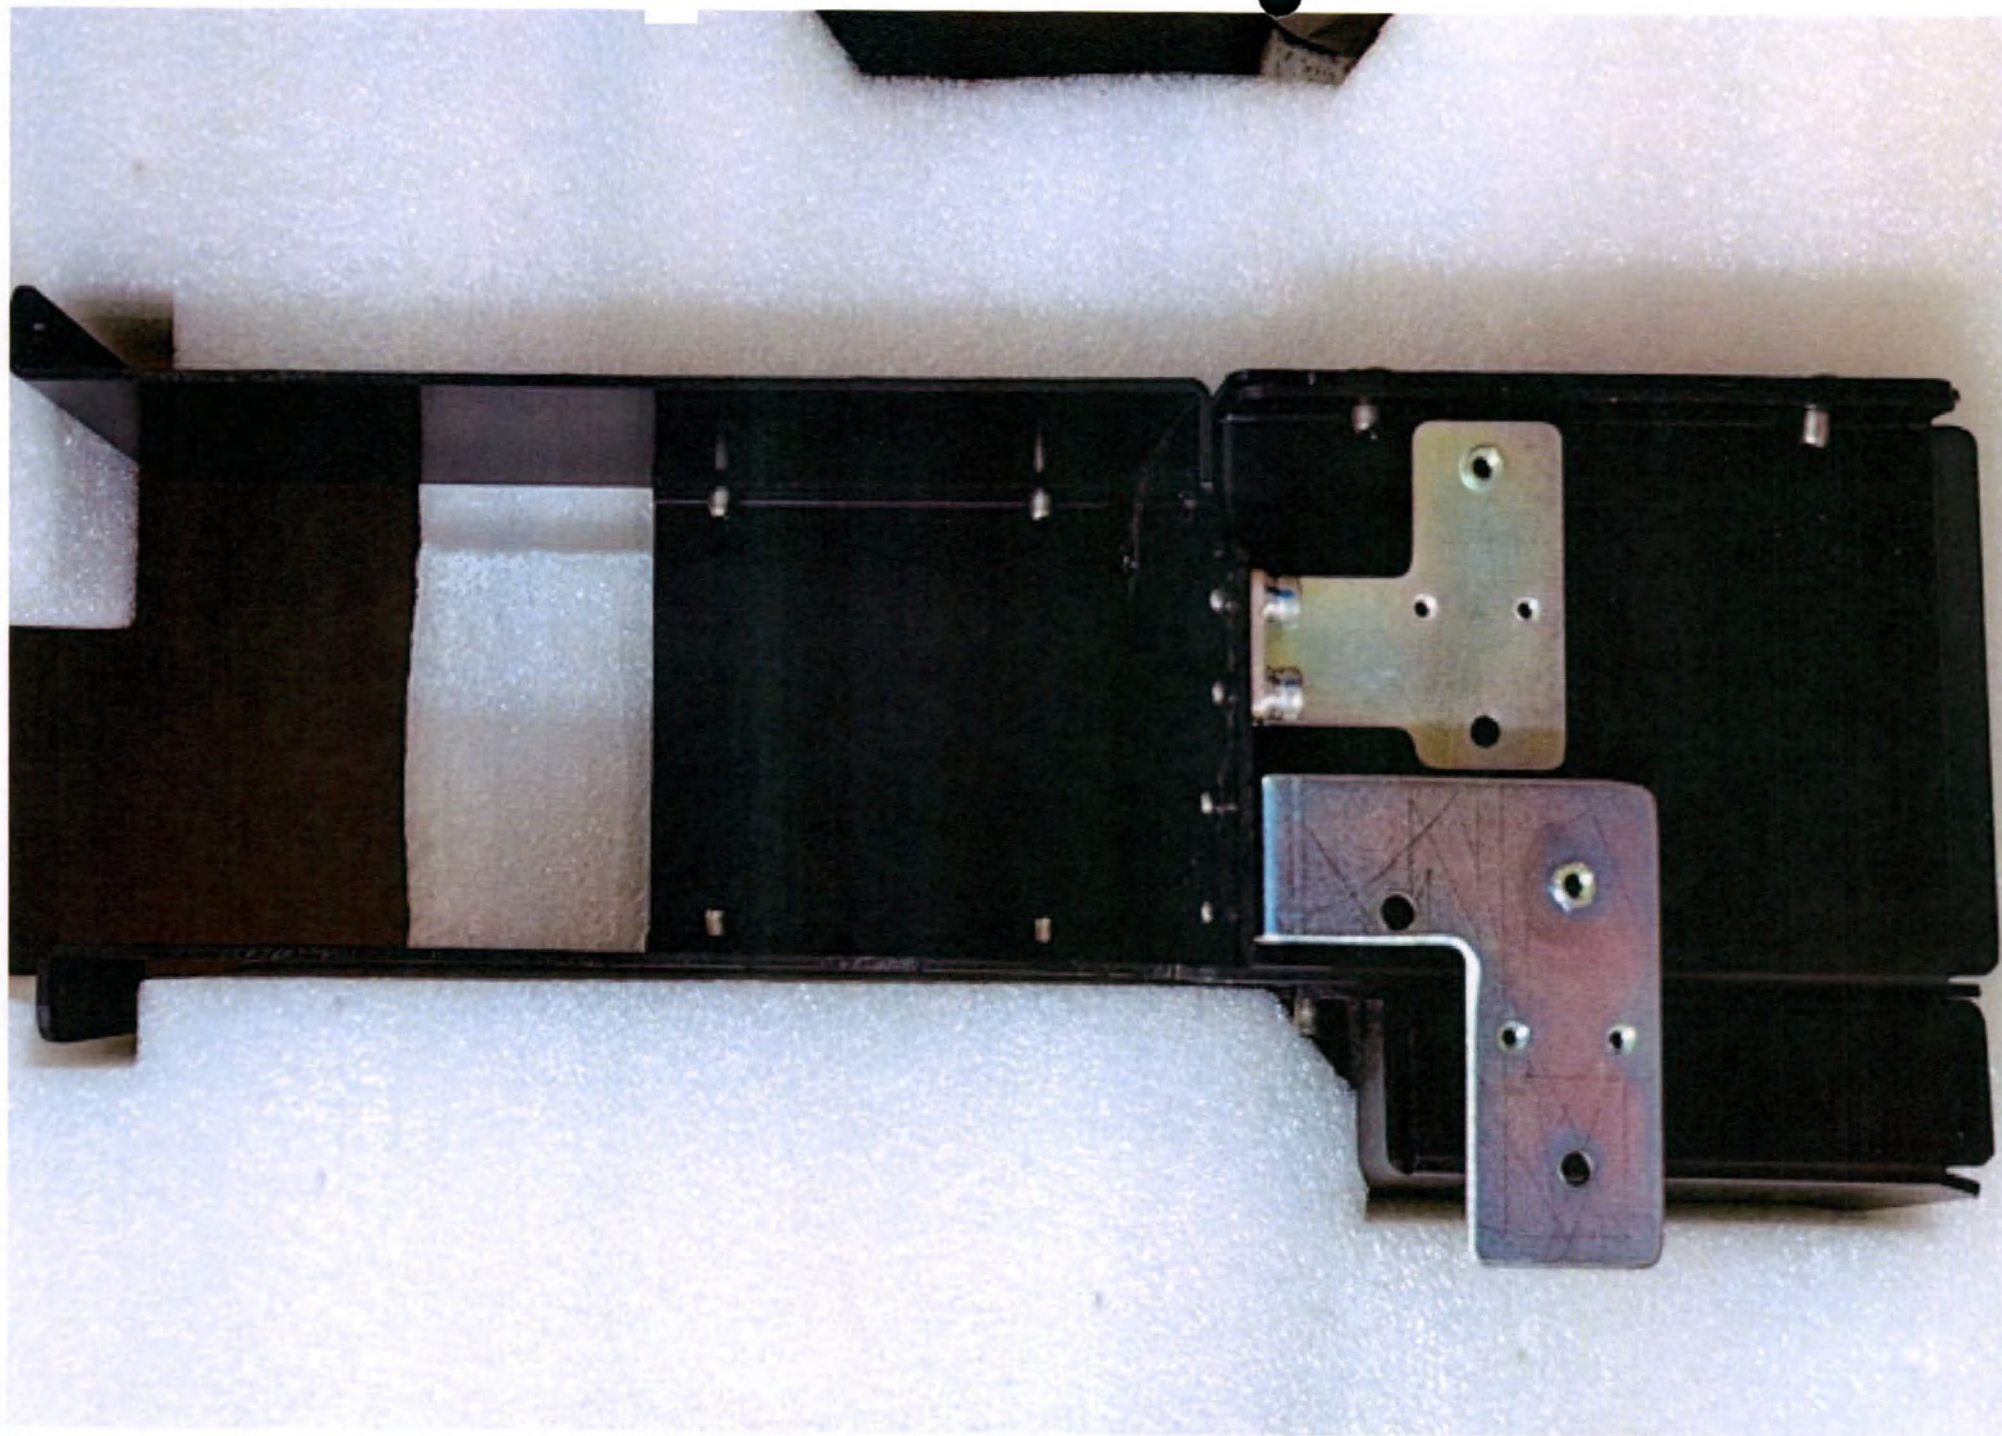


7.1 Держатель ёмкости с разбавителем

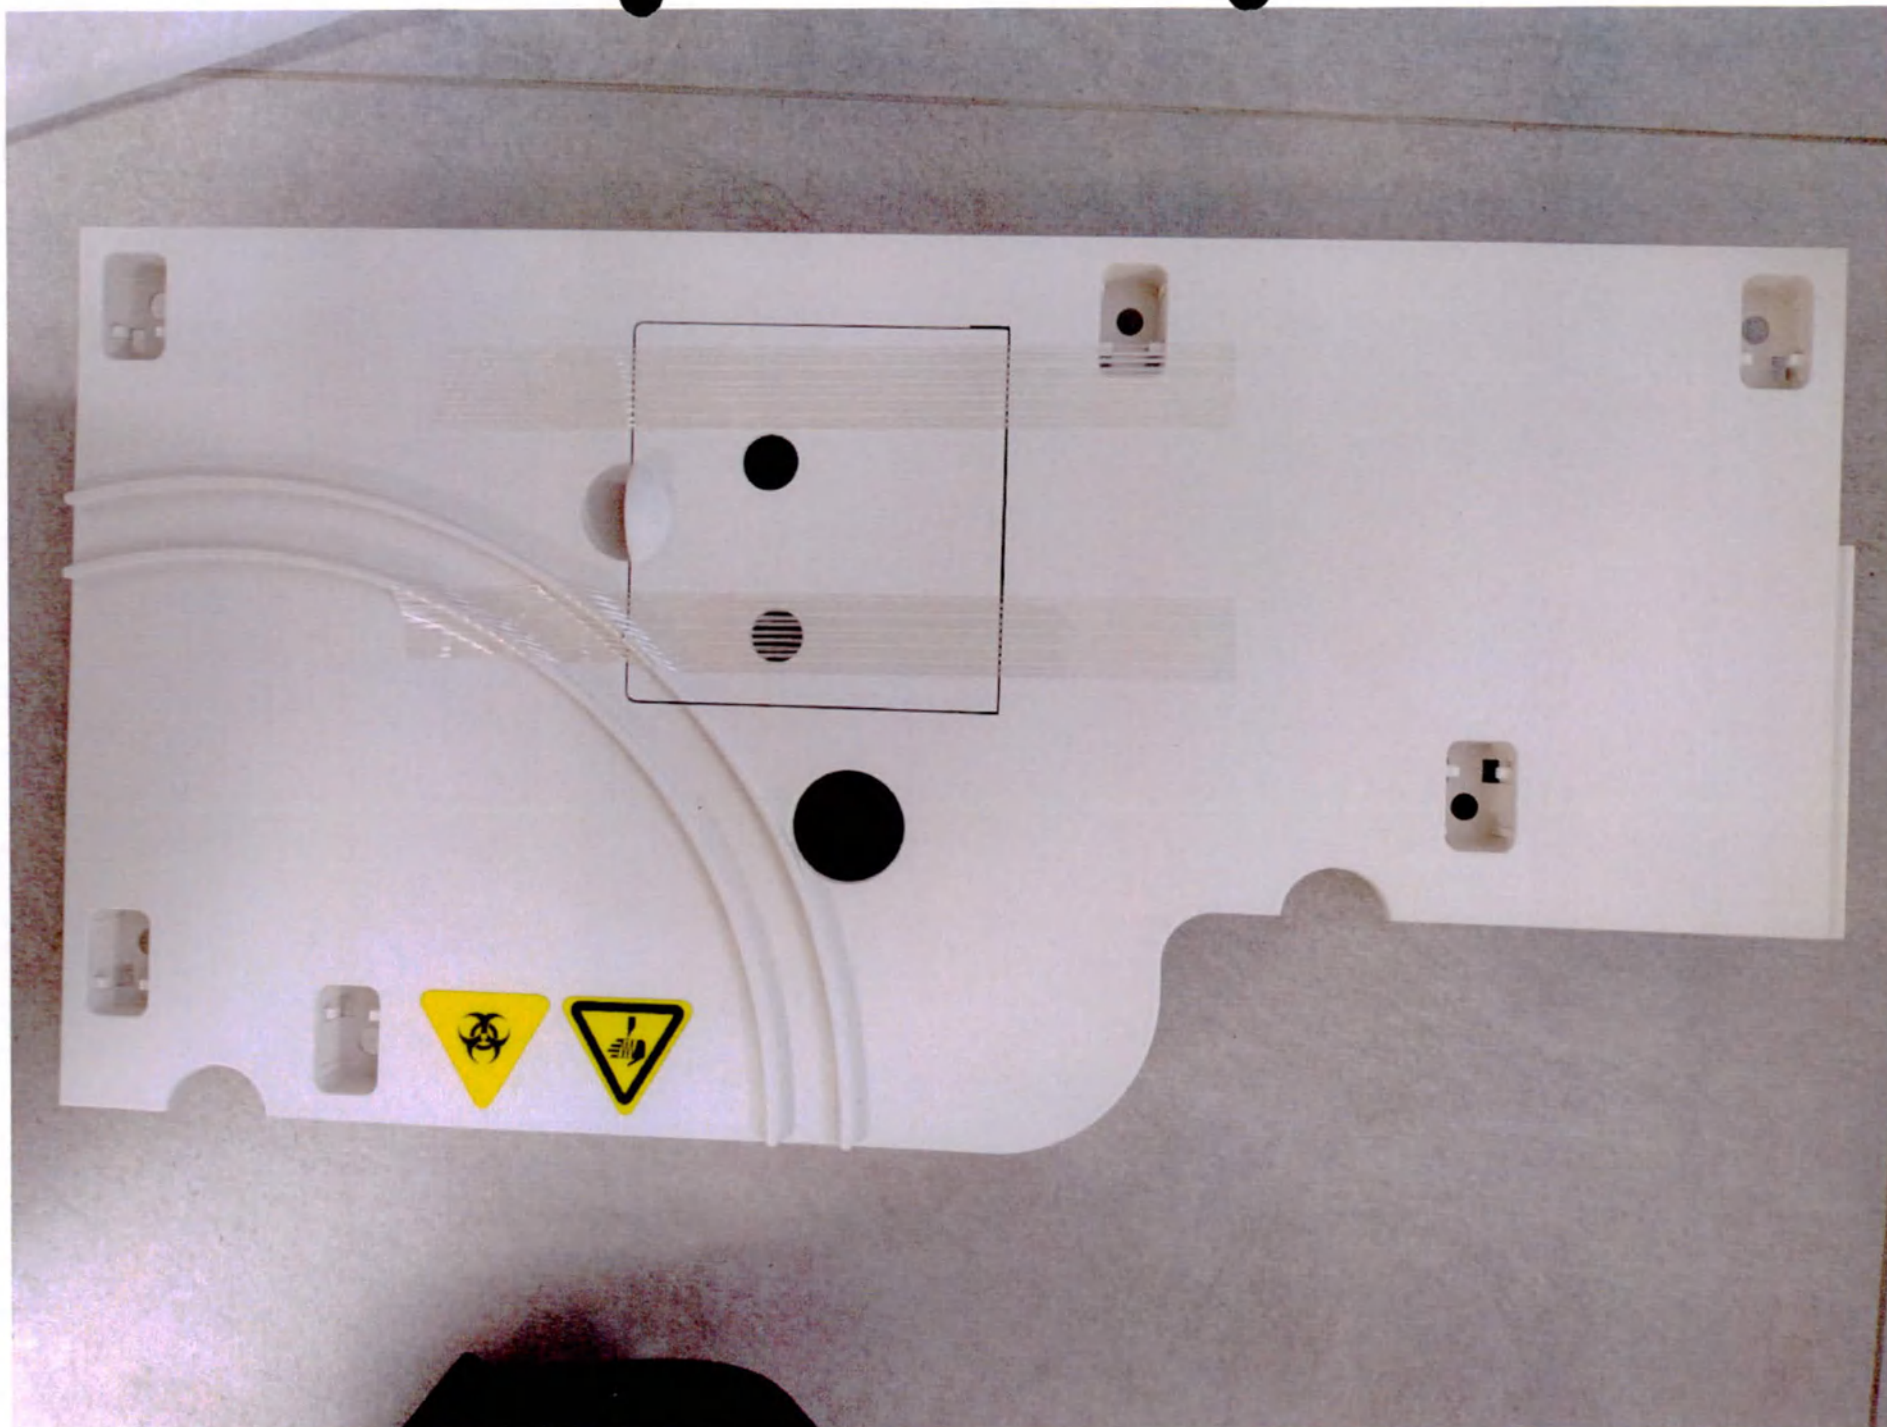

7.2 Передняя панель FSP

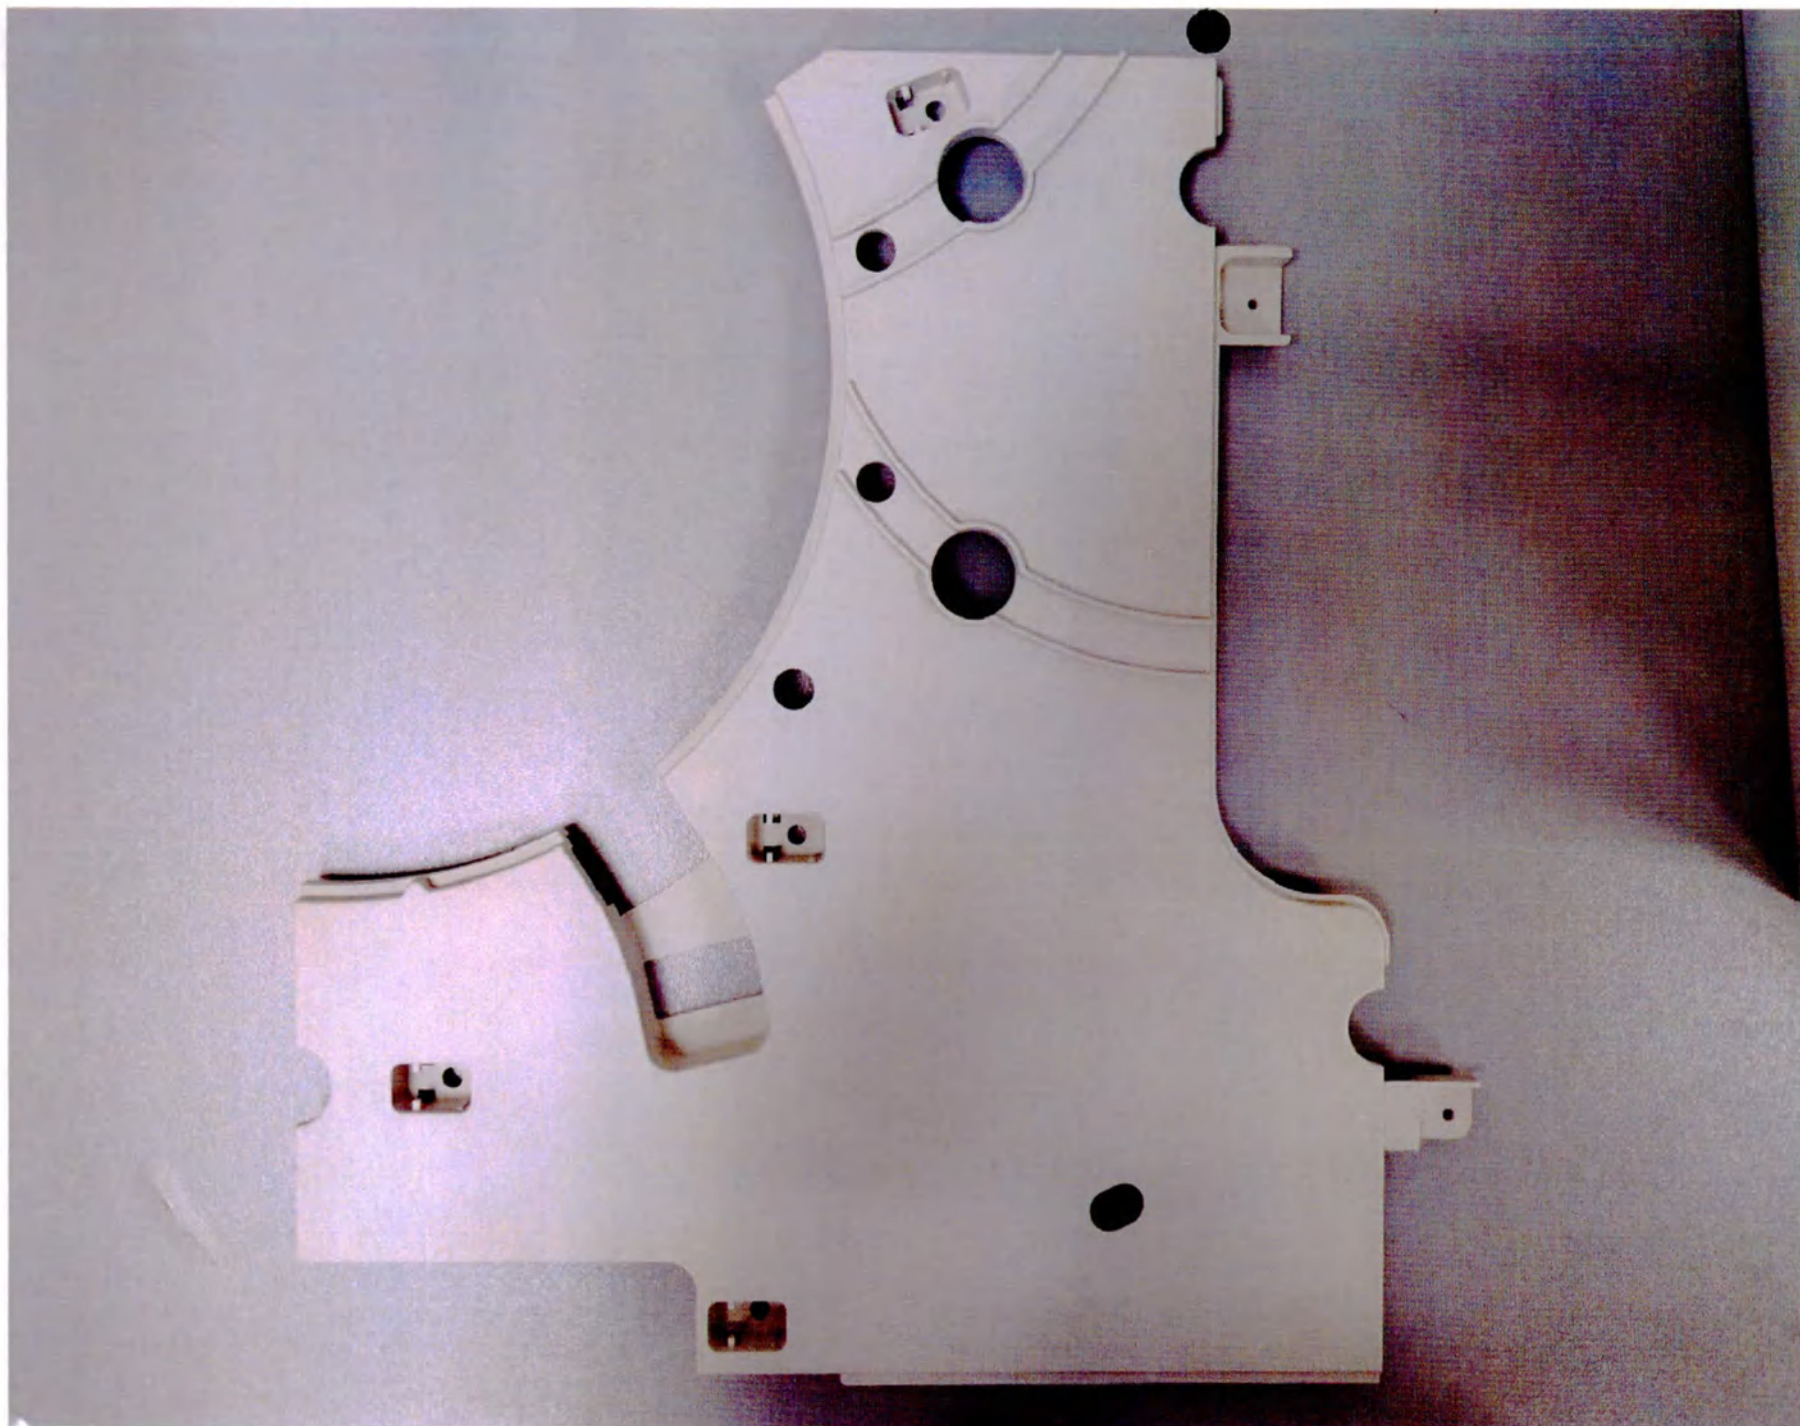

7.3 Боковая панель FSP

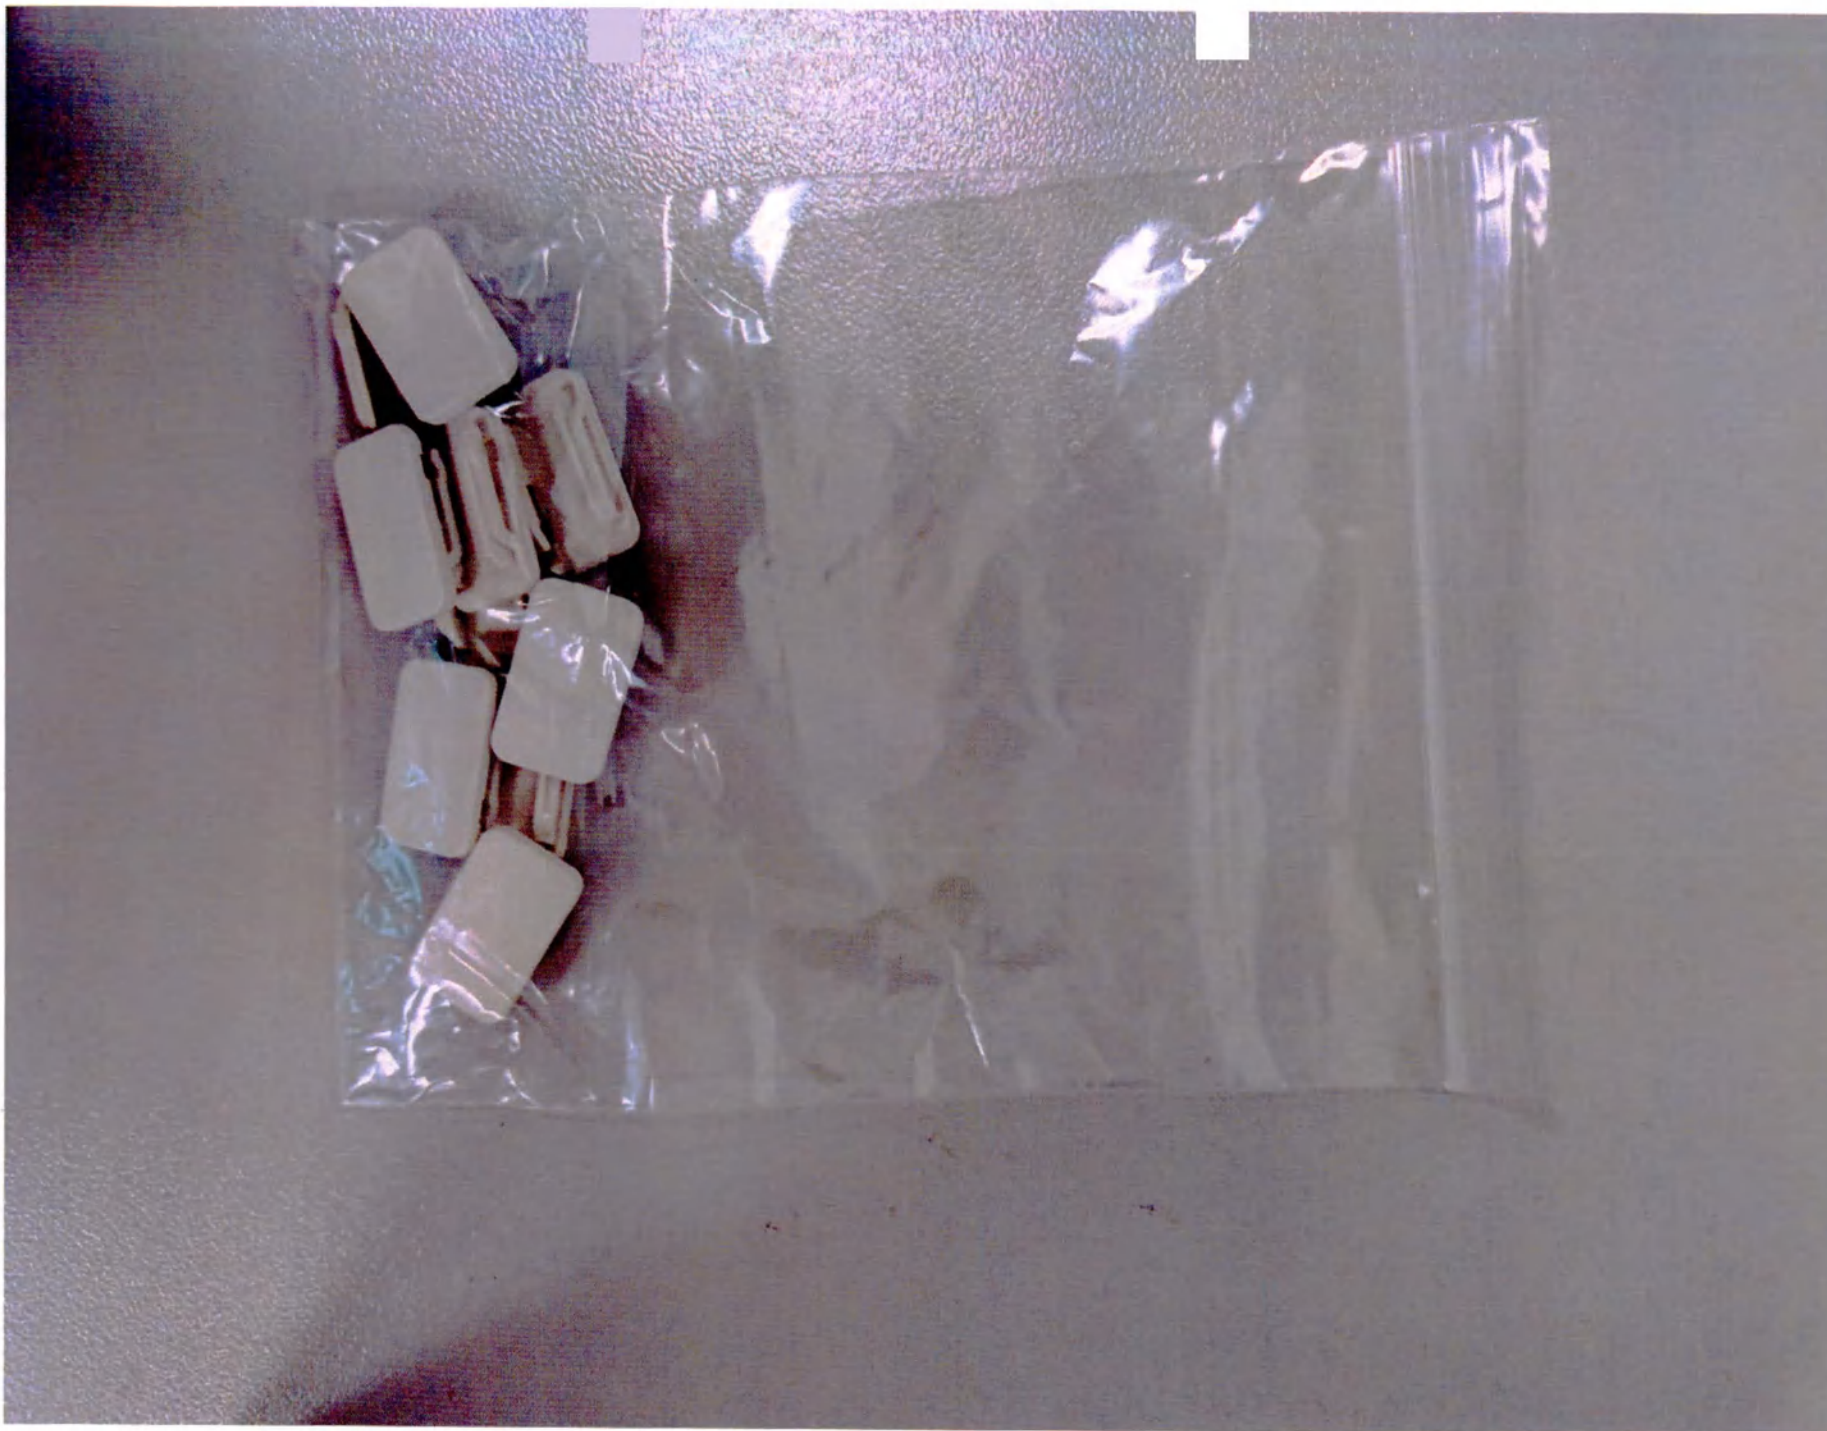

7.4 Колпачок на винт



8. Кабель RS-232



9. Кабель LAN сетевой 2 м



10. Сканер штрих-кодов (Newland, модель NLS-HR21)



11. Канистра для жидких отходов (10 л)



12. Канистра для очищенной воды (10 л)



13. Канистра для промывающего раствора Wash Buffer (10 л)



14. Канистра для промывающего раствора System Wash (4 л)




15. Флакон для субстрата А (белый)




16. Флакон для субстрата В (коричневый)



17. Предохранитель

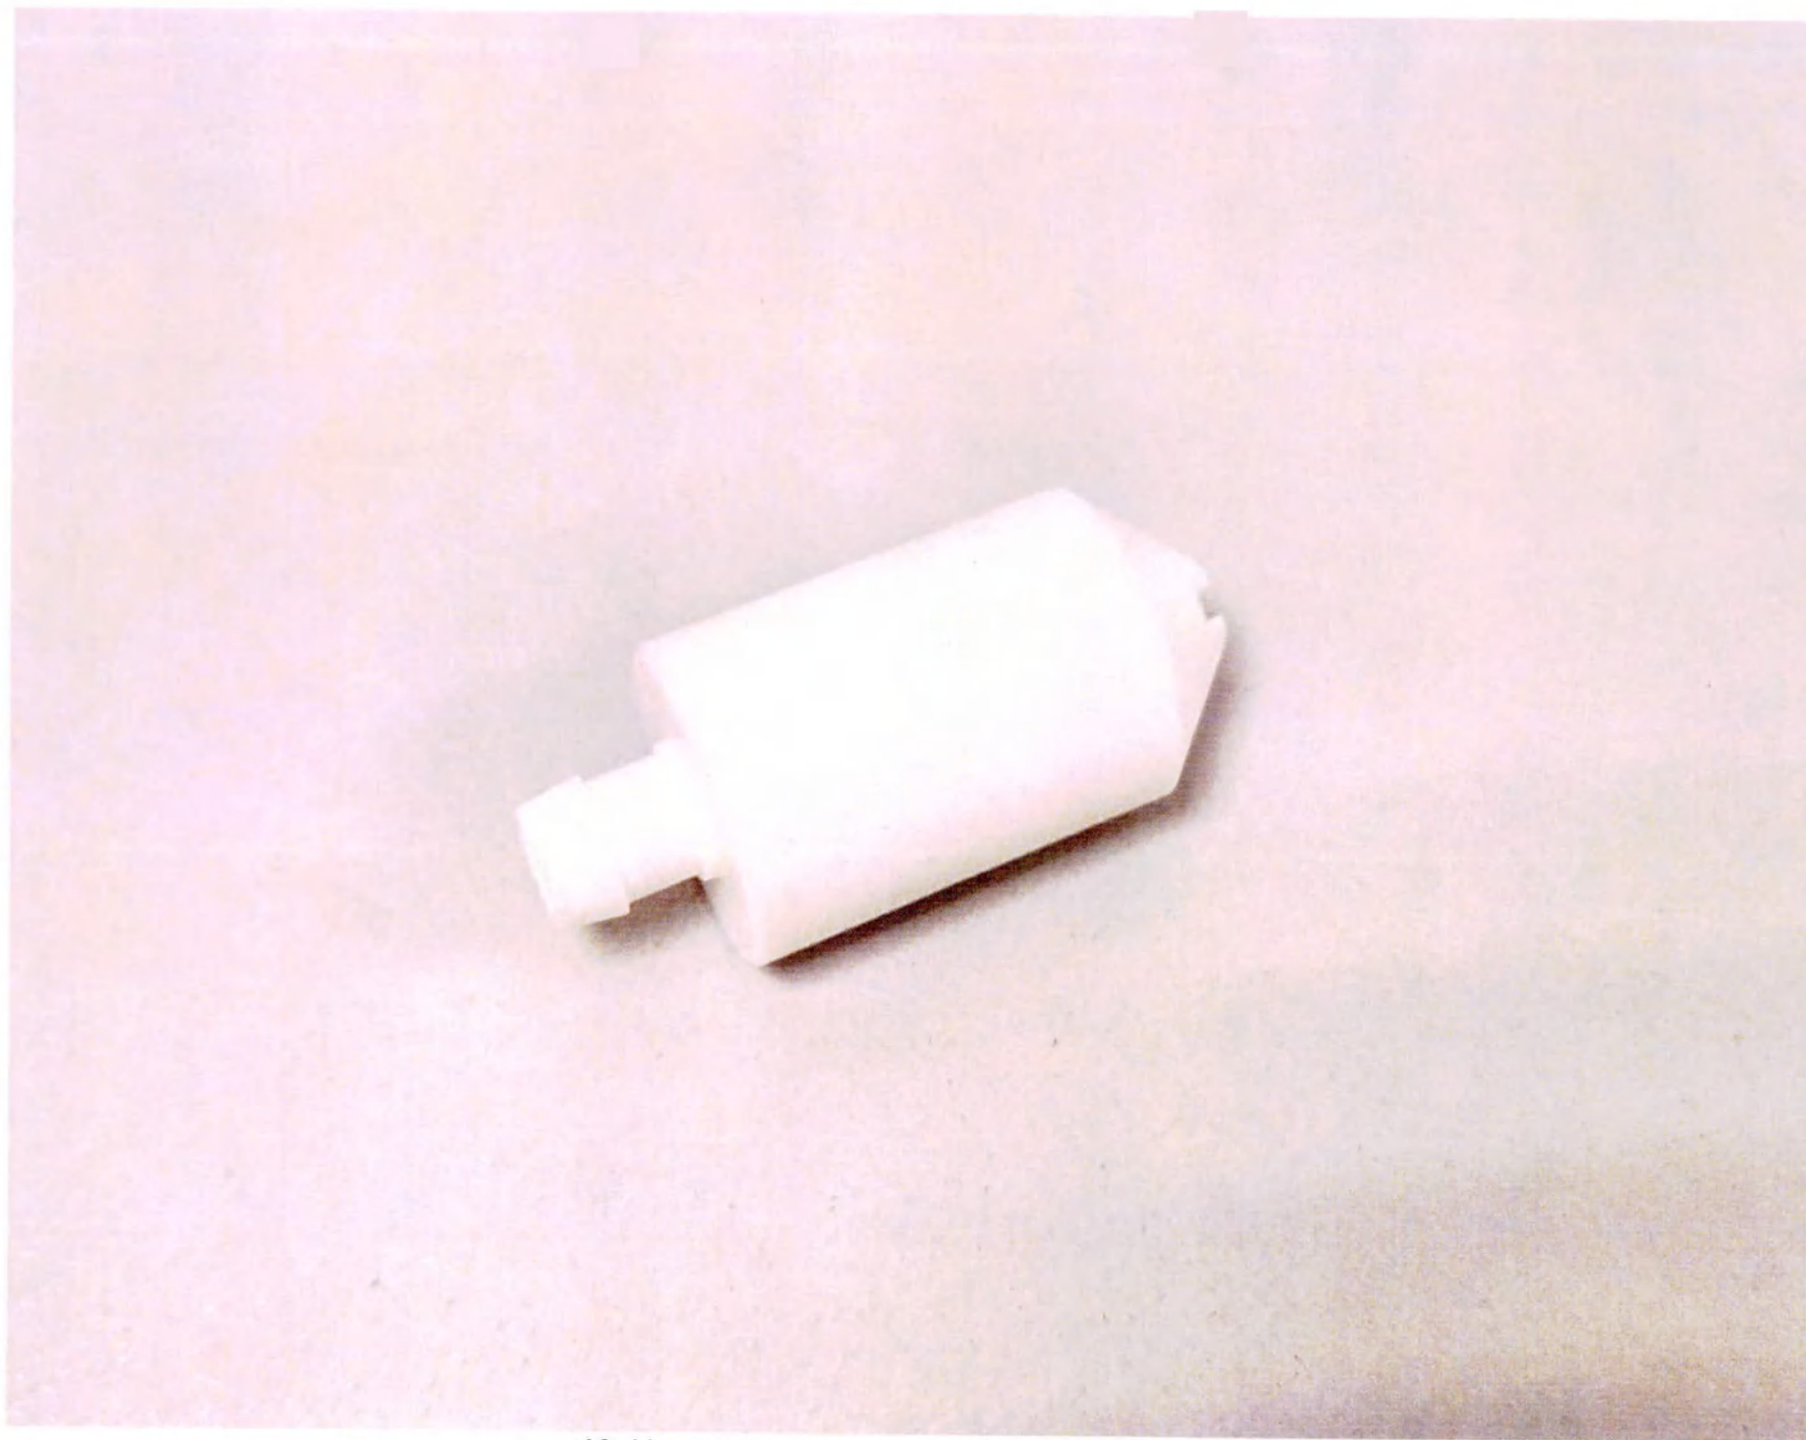

18. Утяжелитель для трубки с жидкостью

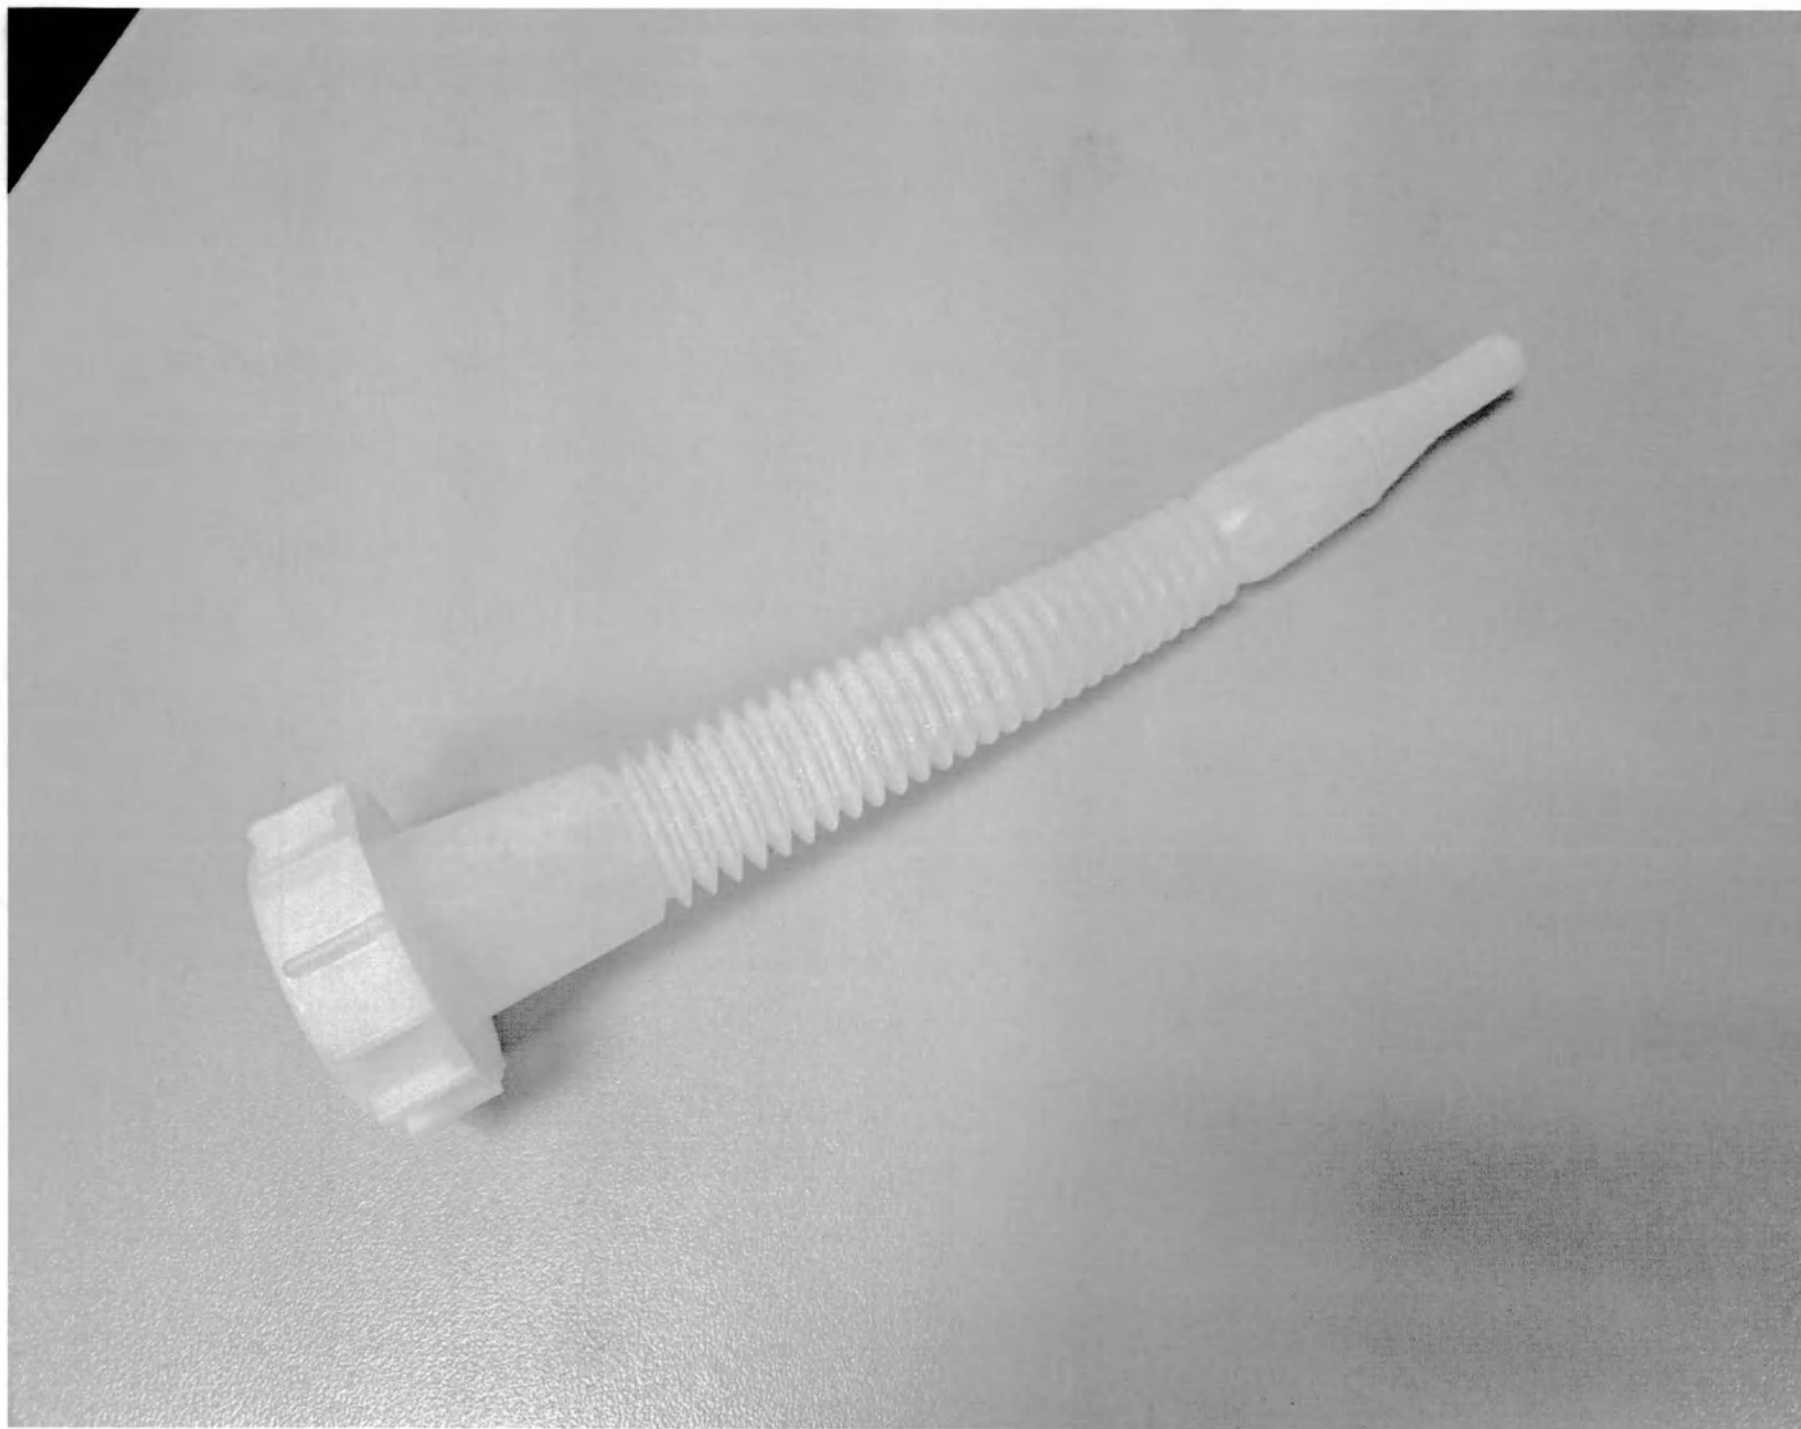

19. Выпускная трубка для канистры жидкостью

Реакционные кюветы, 1000 шт./уп.

REF CMC0601

1000

LOT 20230501-G18

2023-05-01 9C -40°C


2026-04-30

Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
Rm. 100, 10th Ave.
Nanhai Road, South Zone
Zhengzhou, 450010, China
Tel: +86-371-67862118
Website: autobio.com.cn

IVD

Только для профессионального использования
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.

20. Реакционные кюветы, 1000 шт./уп.

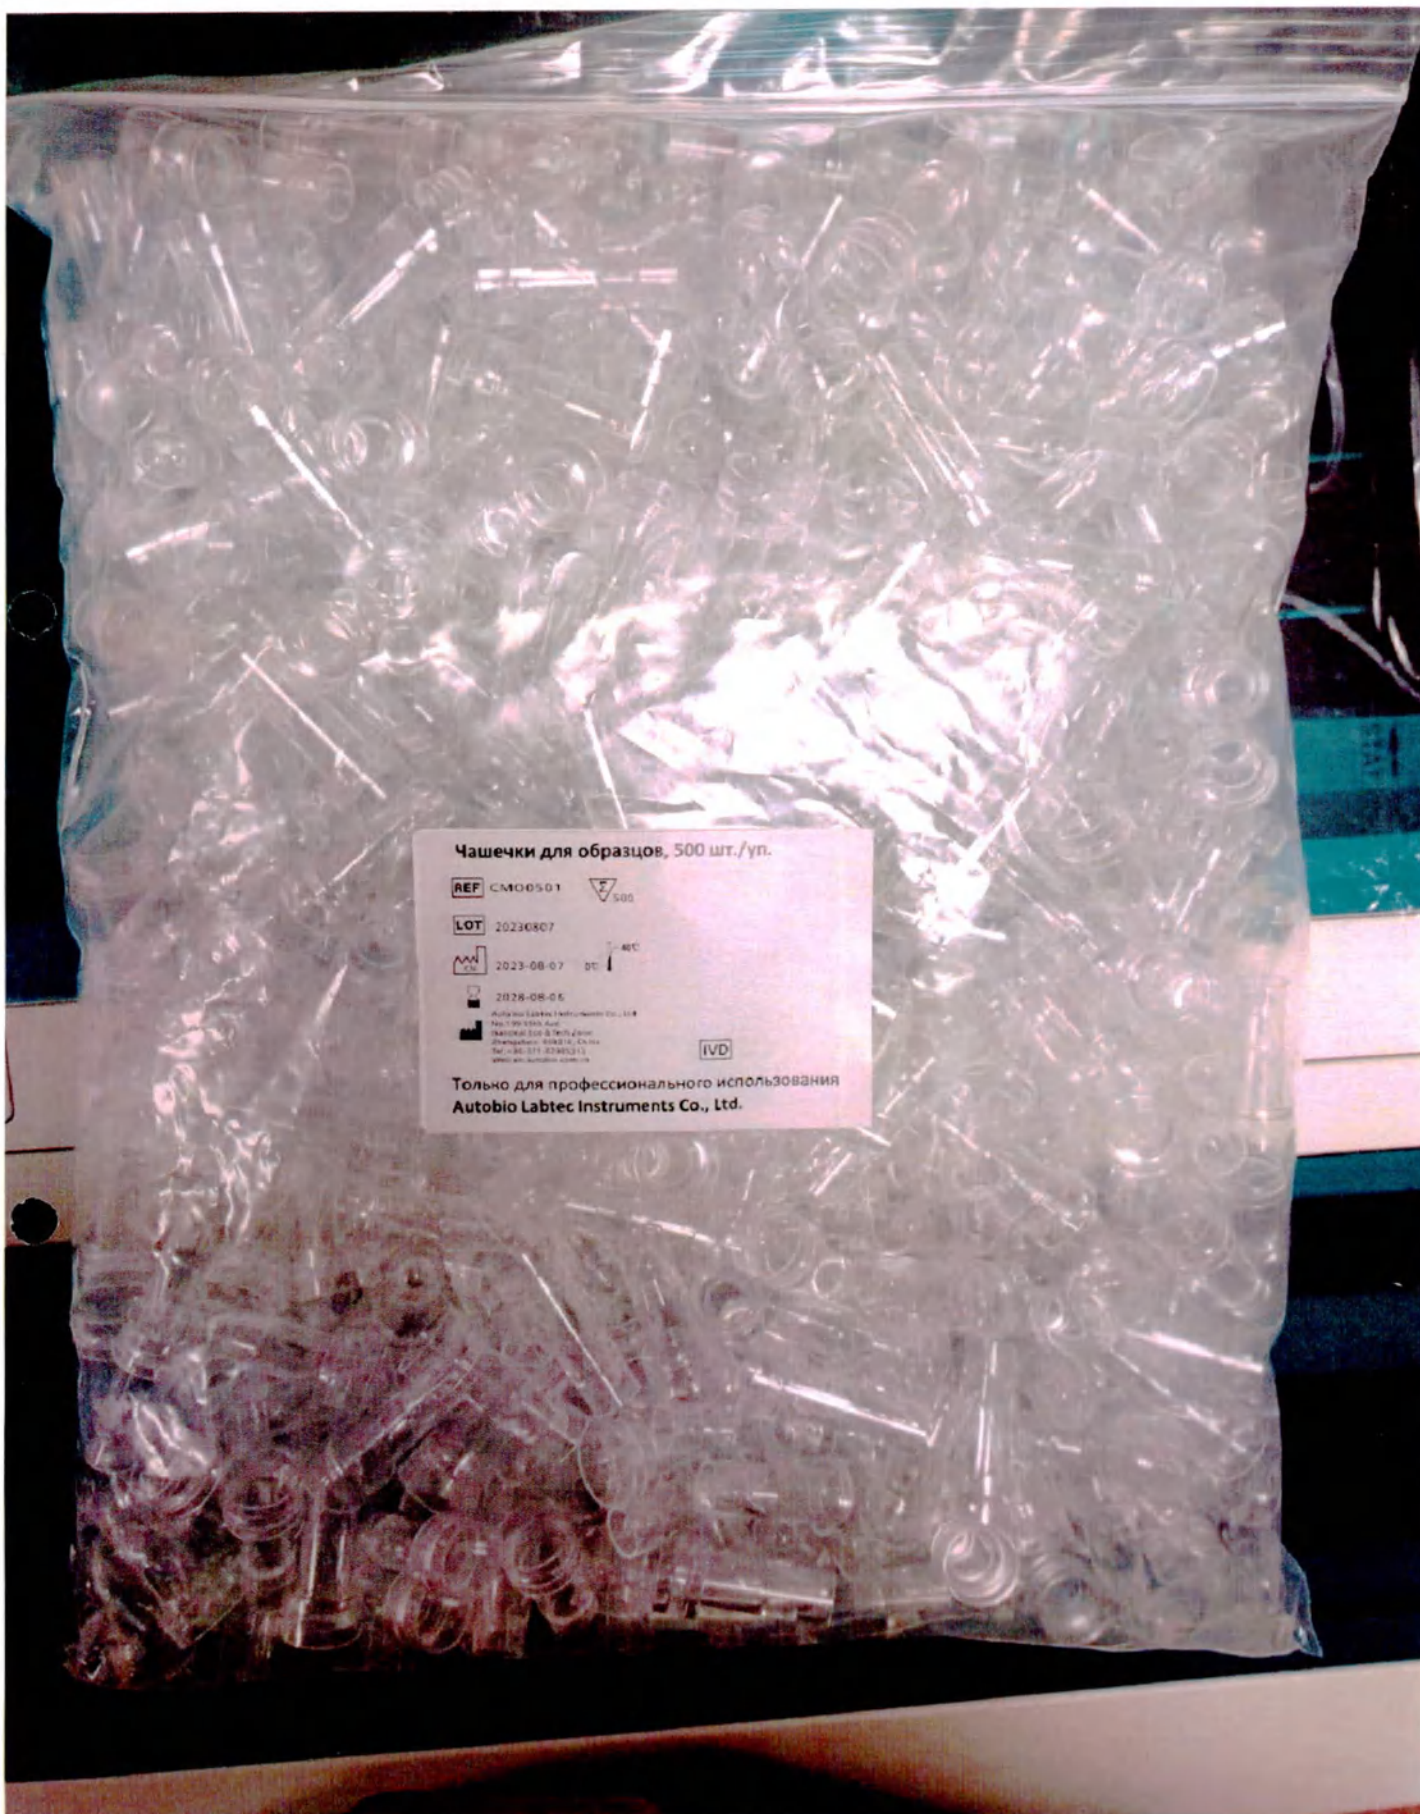

Чашечки для образцов, 500 шт./уп.

REF CMO0501

500

LOT 20230807

2023-08-07

DT -40°C

2028-08-06

Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.

IVD

Только для профессионального использования
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.


21. Чашечки для образцов, 500 шт./уп.




22. Штатив 13 мм для образцов




23. Штатив 16 мм для образцов

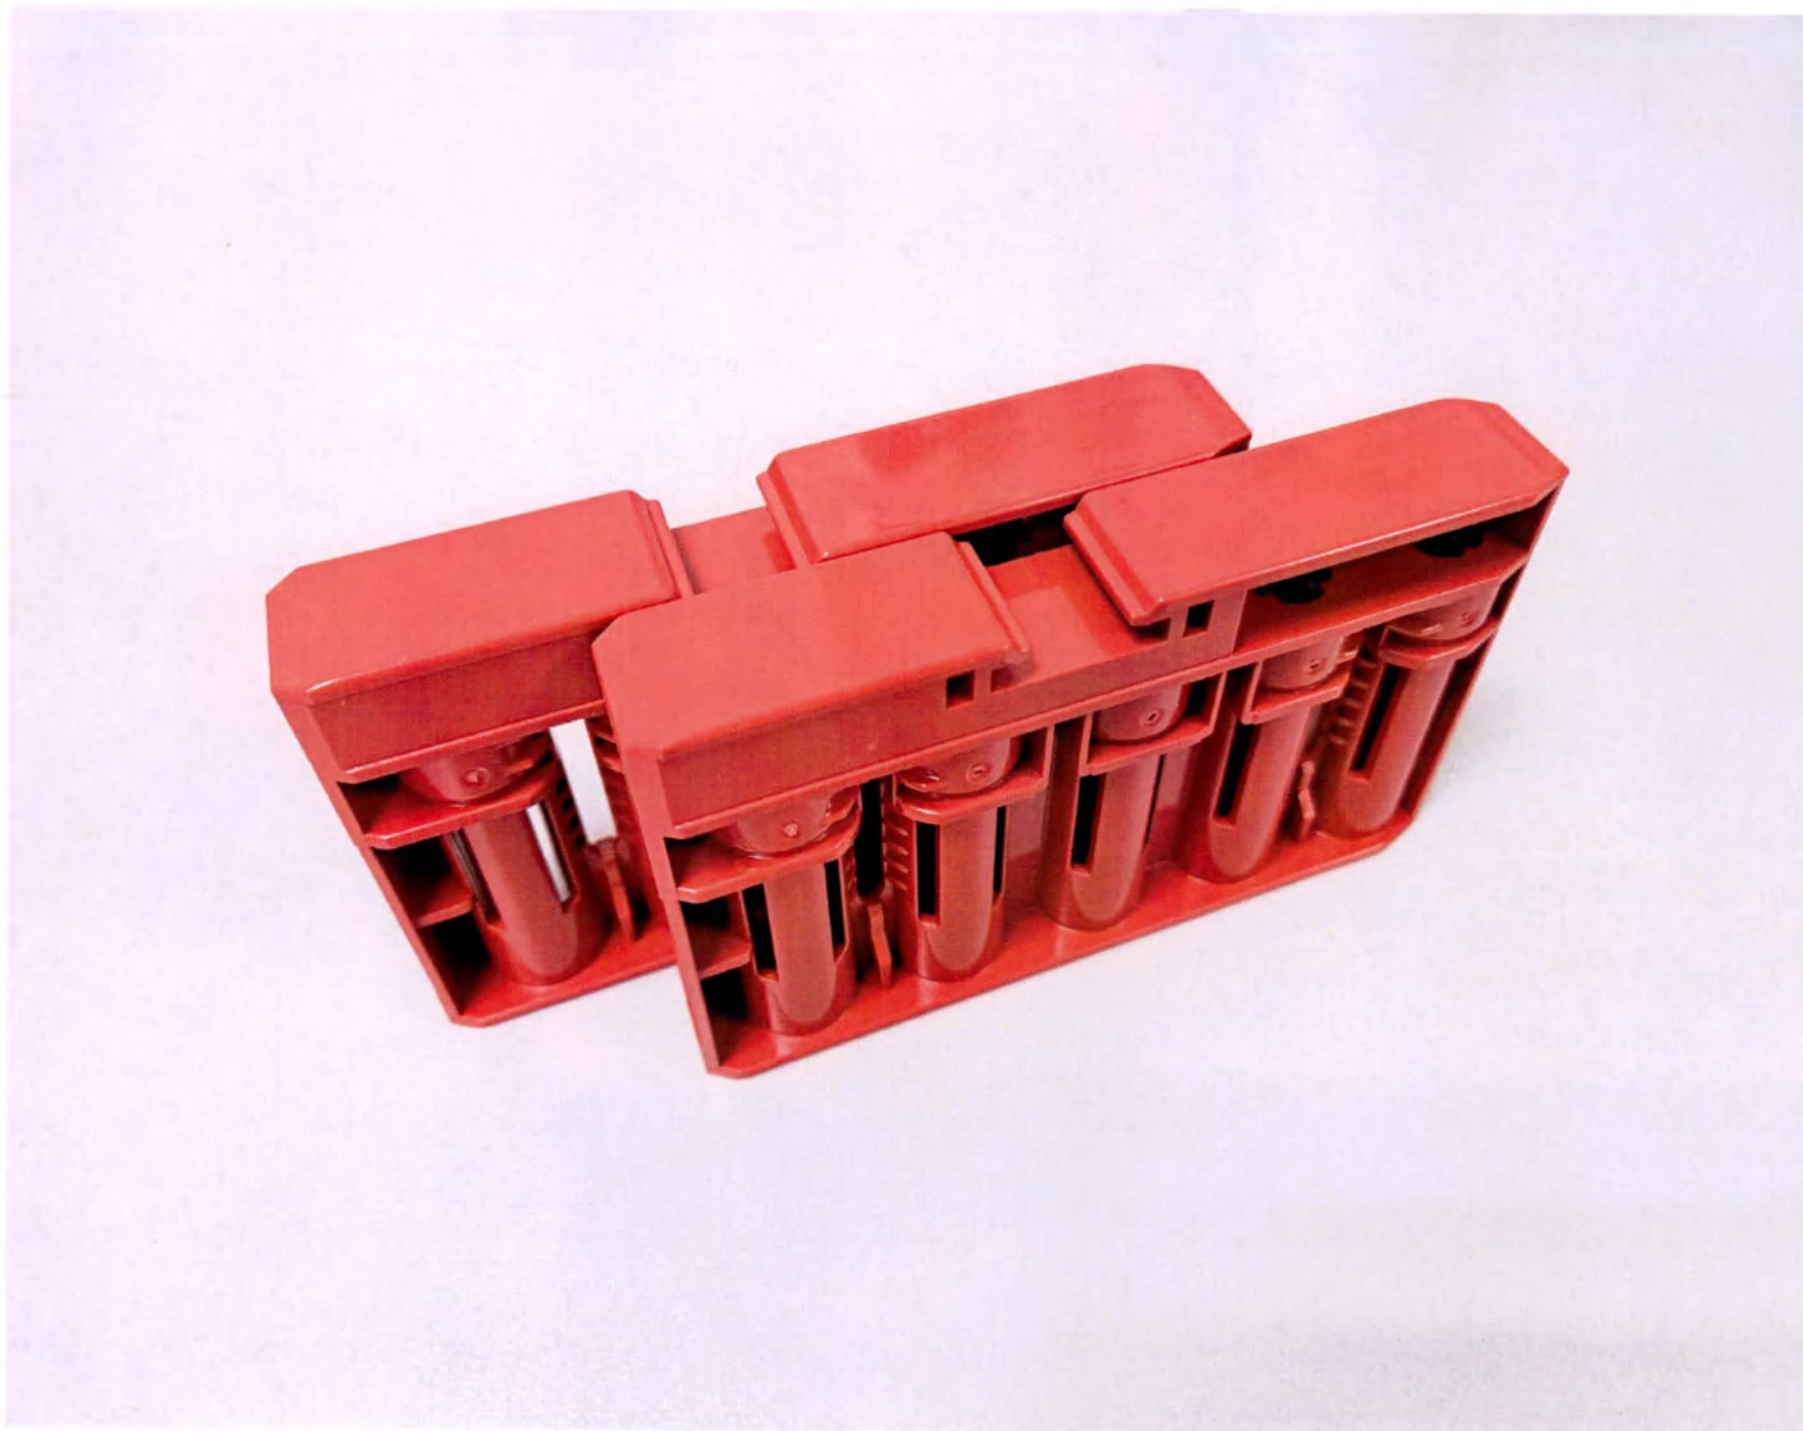


24. Штатив для срочных проб

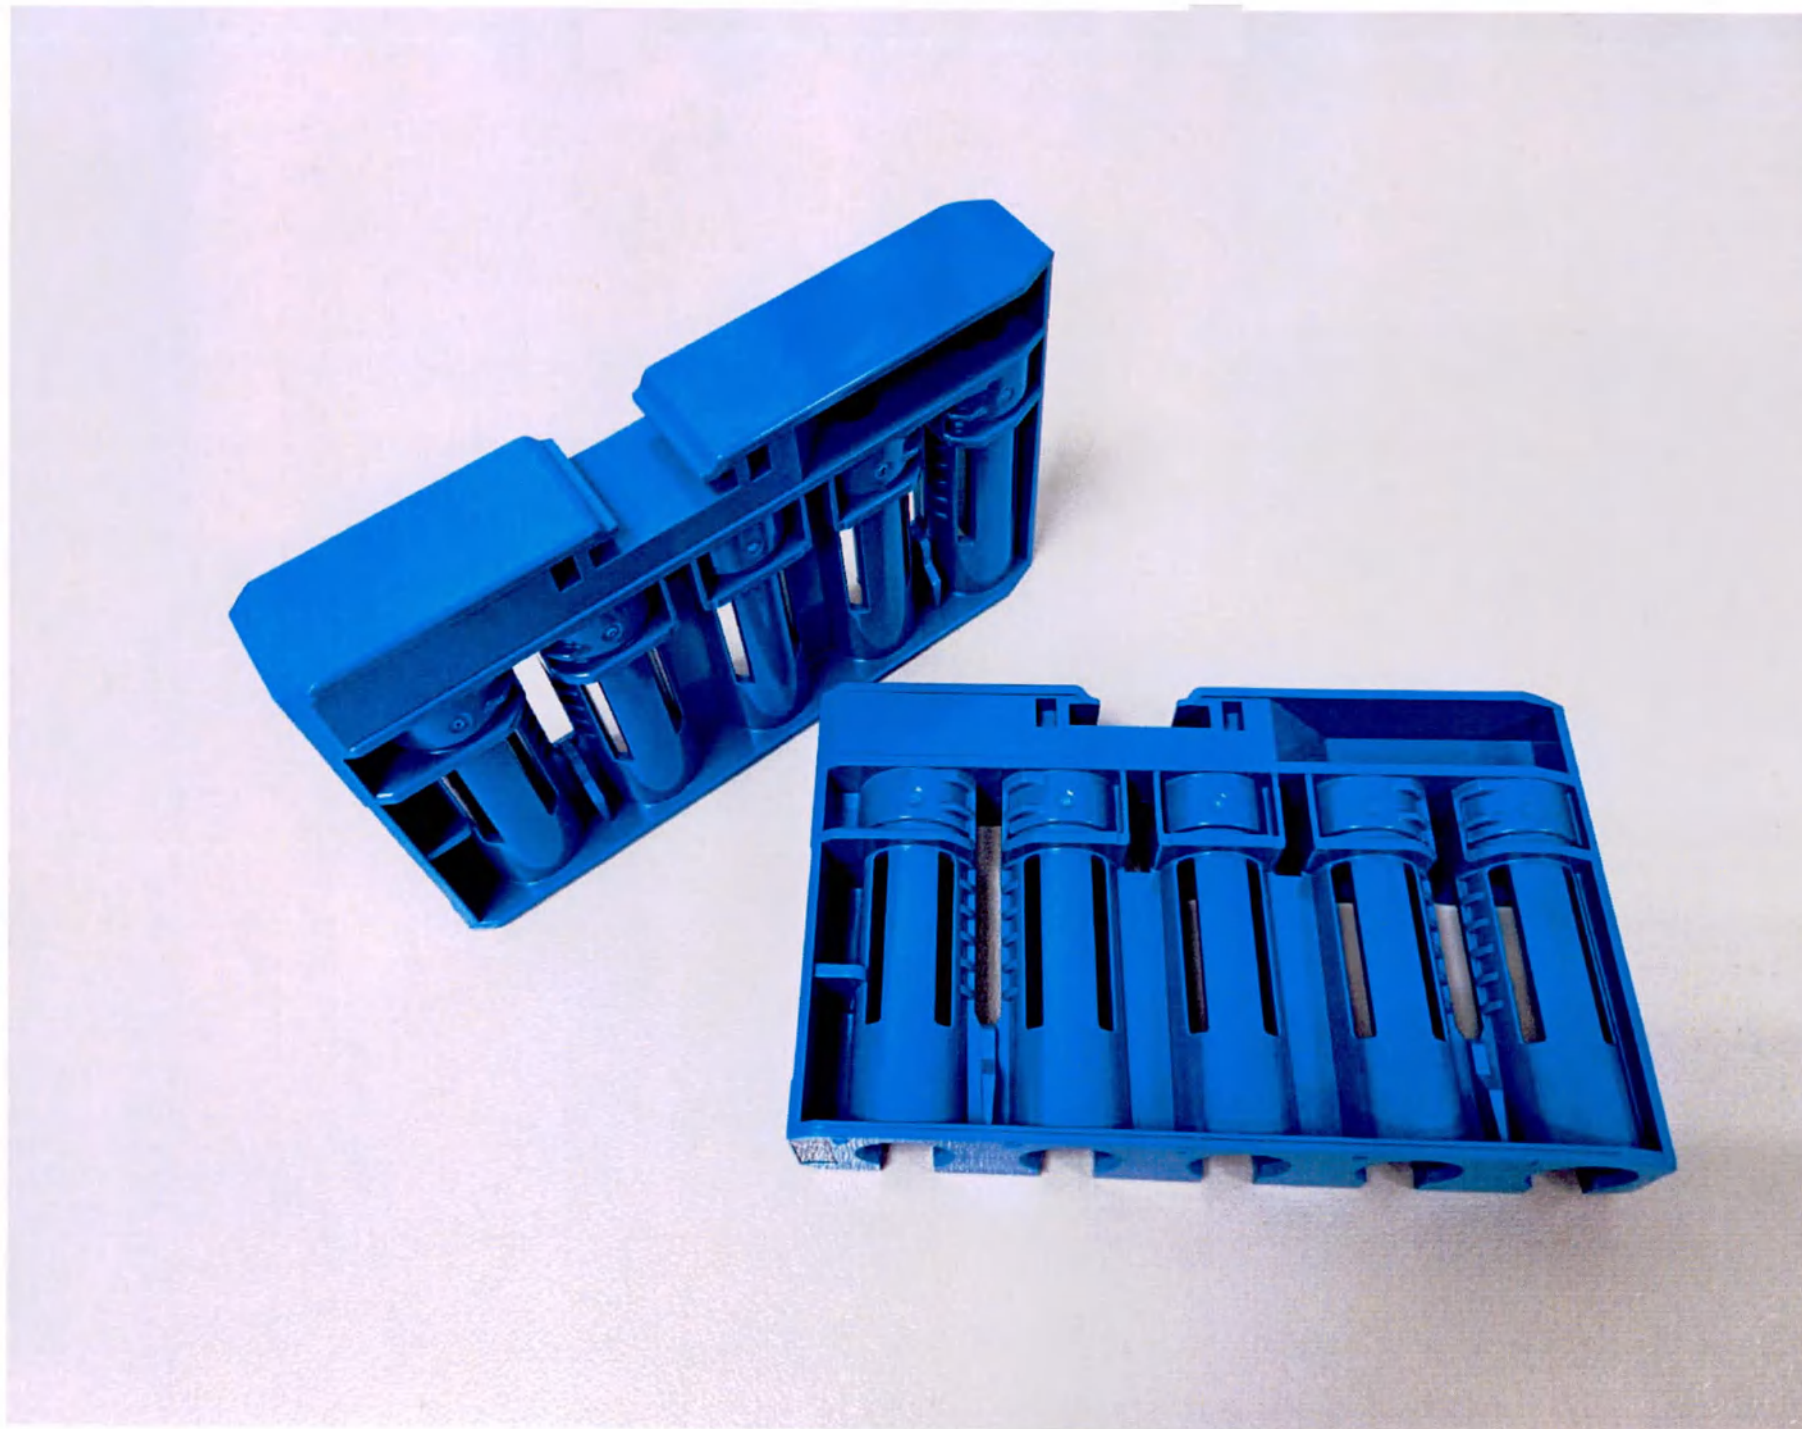

25. Штатив для калибраторов

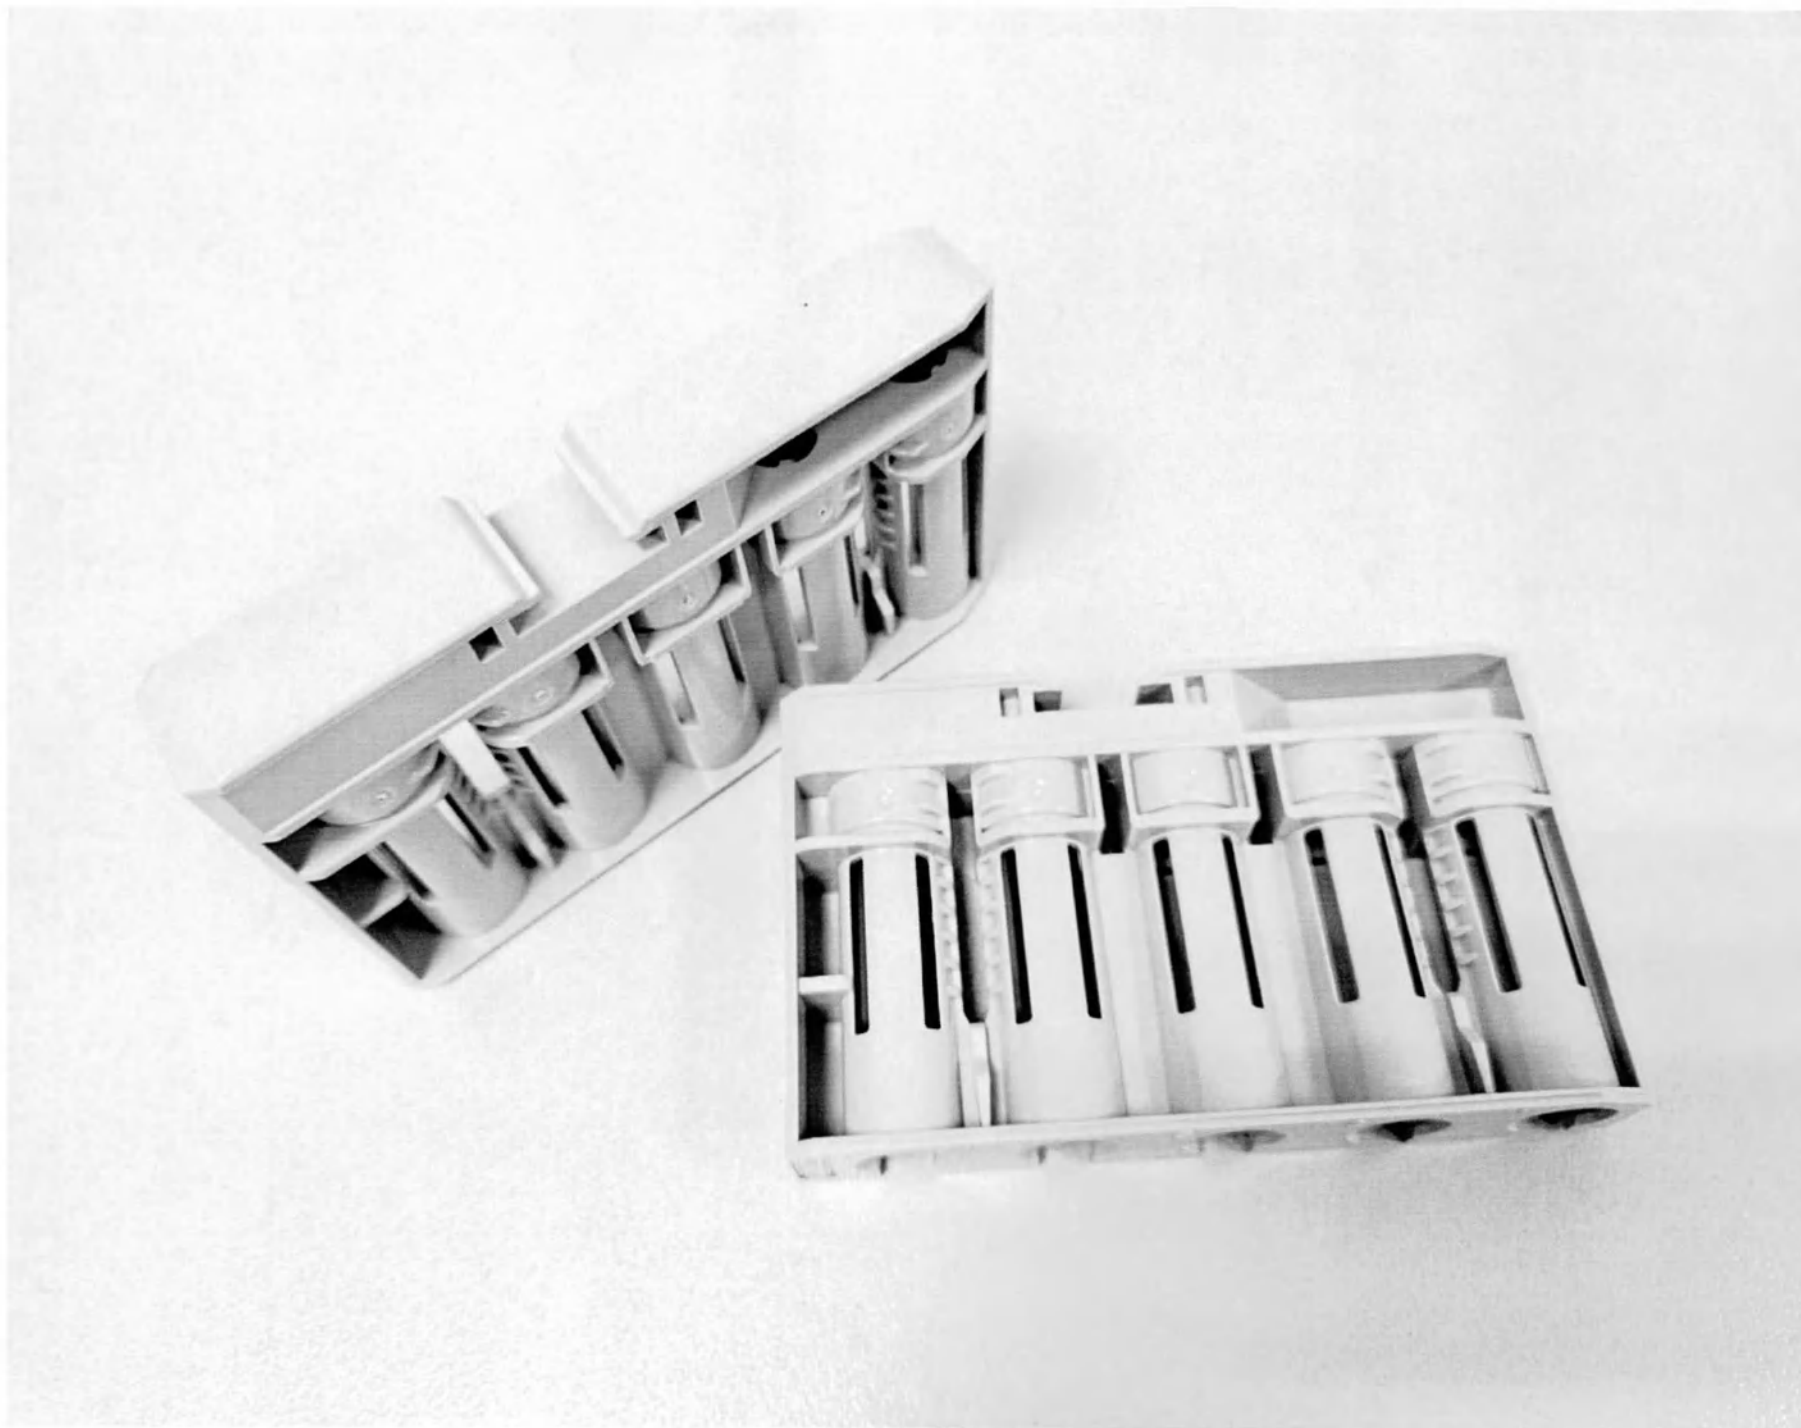

26. Штатив для контрольных материалов

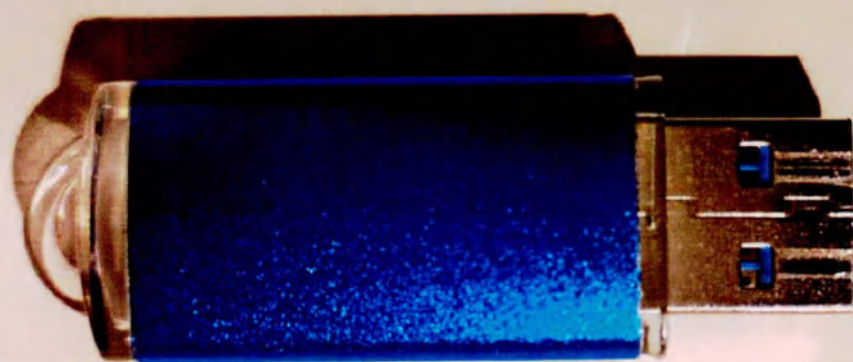


27. USB-флеш-накопитель



28. Контейнер для твердых отходов I



29. Контейнер для твердых отходов II

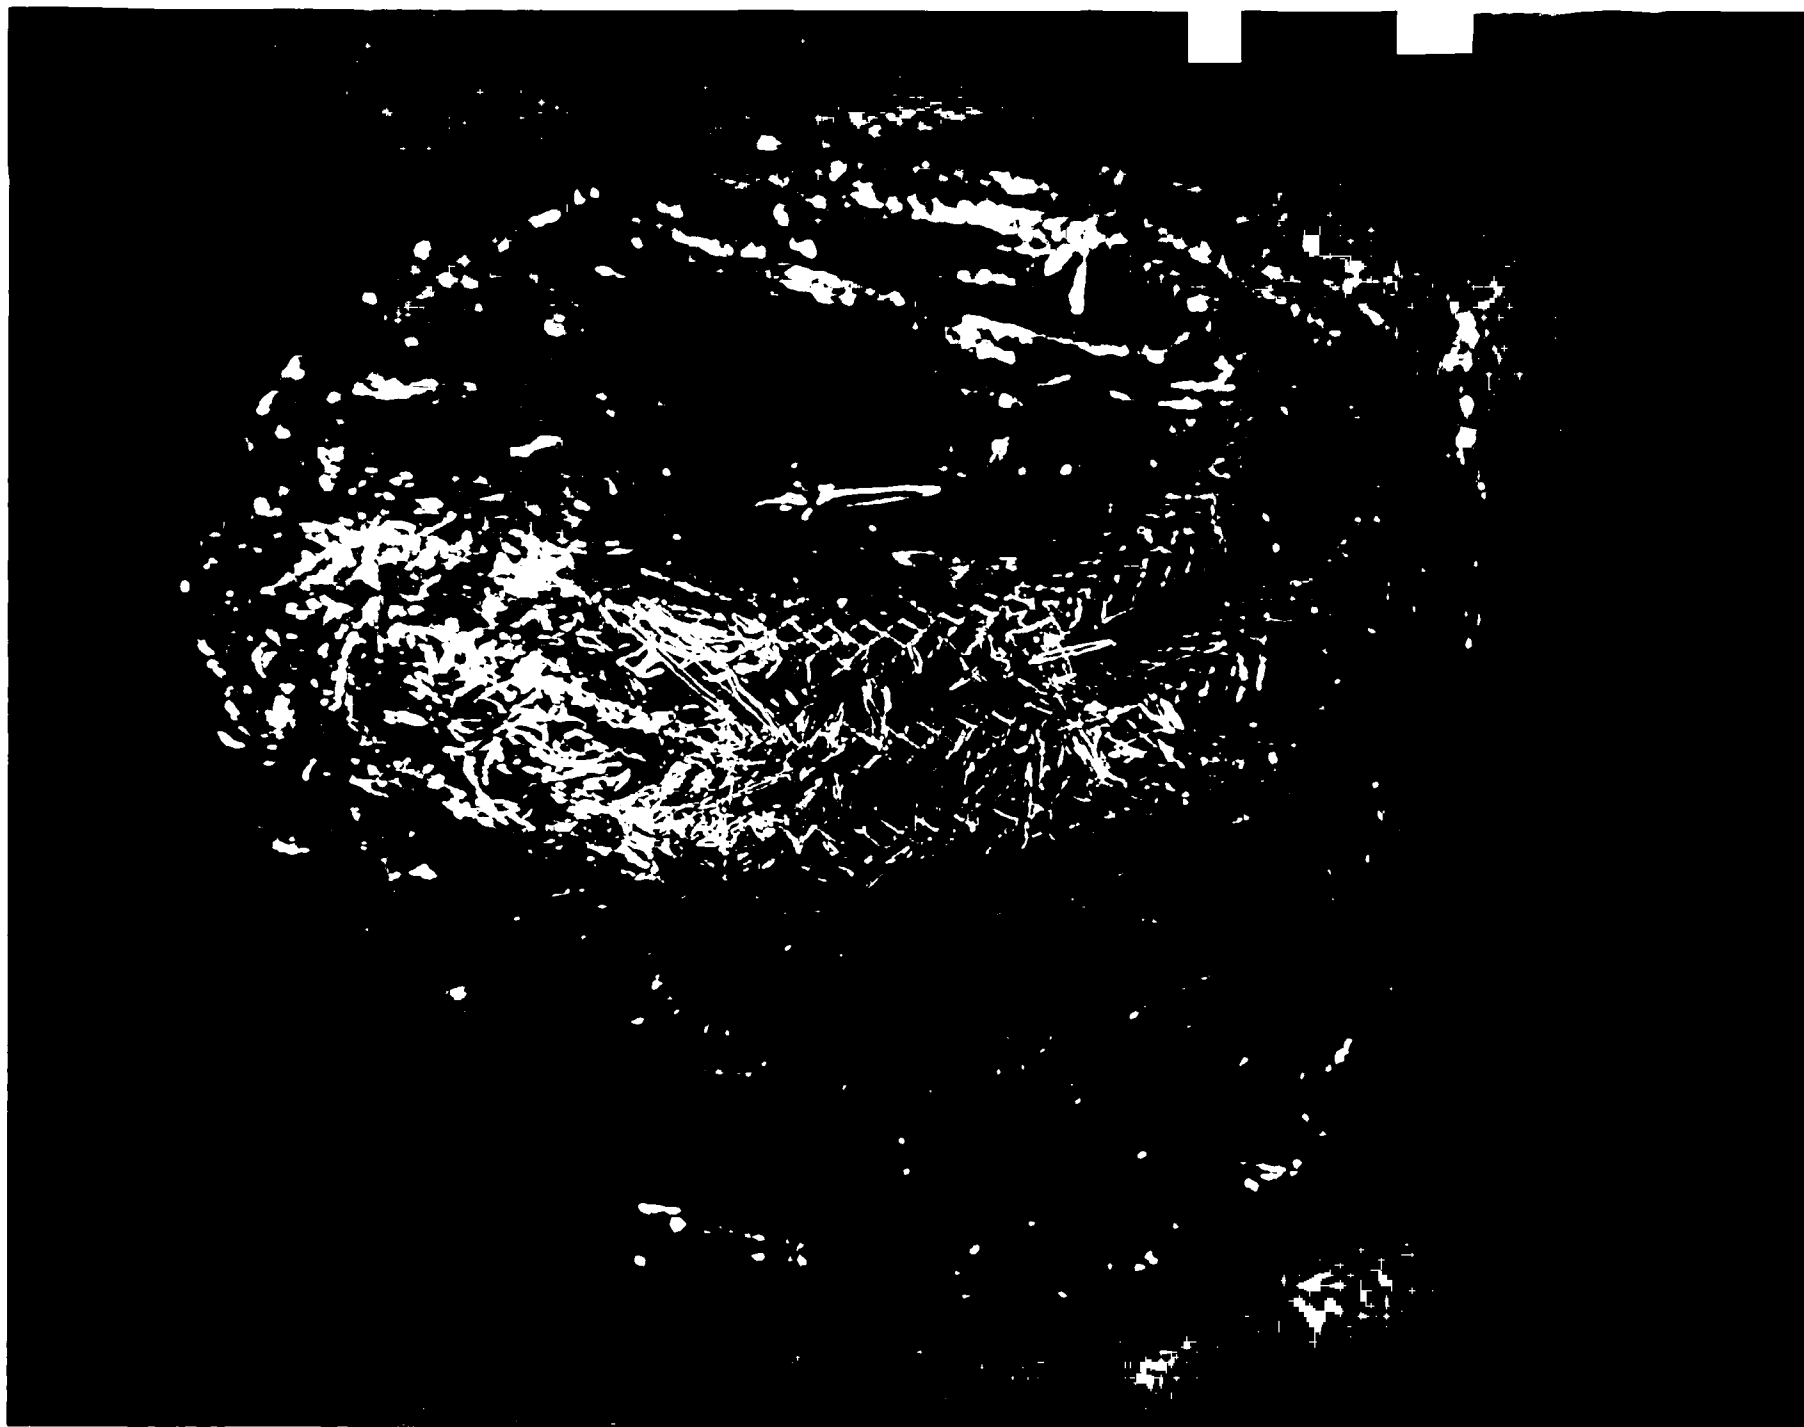

Принадлежности. 1. Трубка ПВХ (15 м)




2. Силиконовая трубка (0,5 м)




3. Колпачок на винт



4. Набор сервисных инструментов

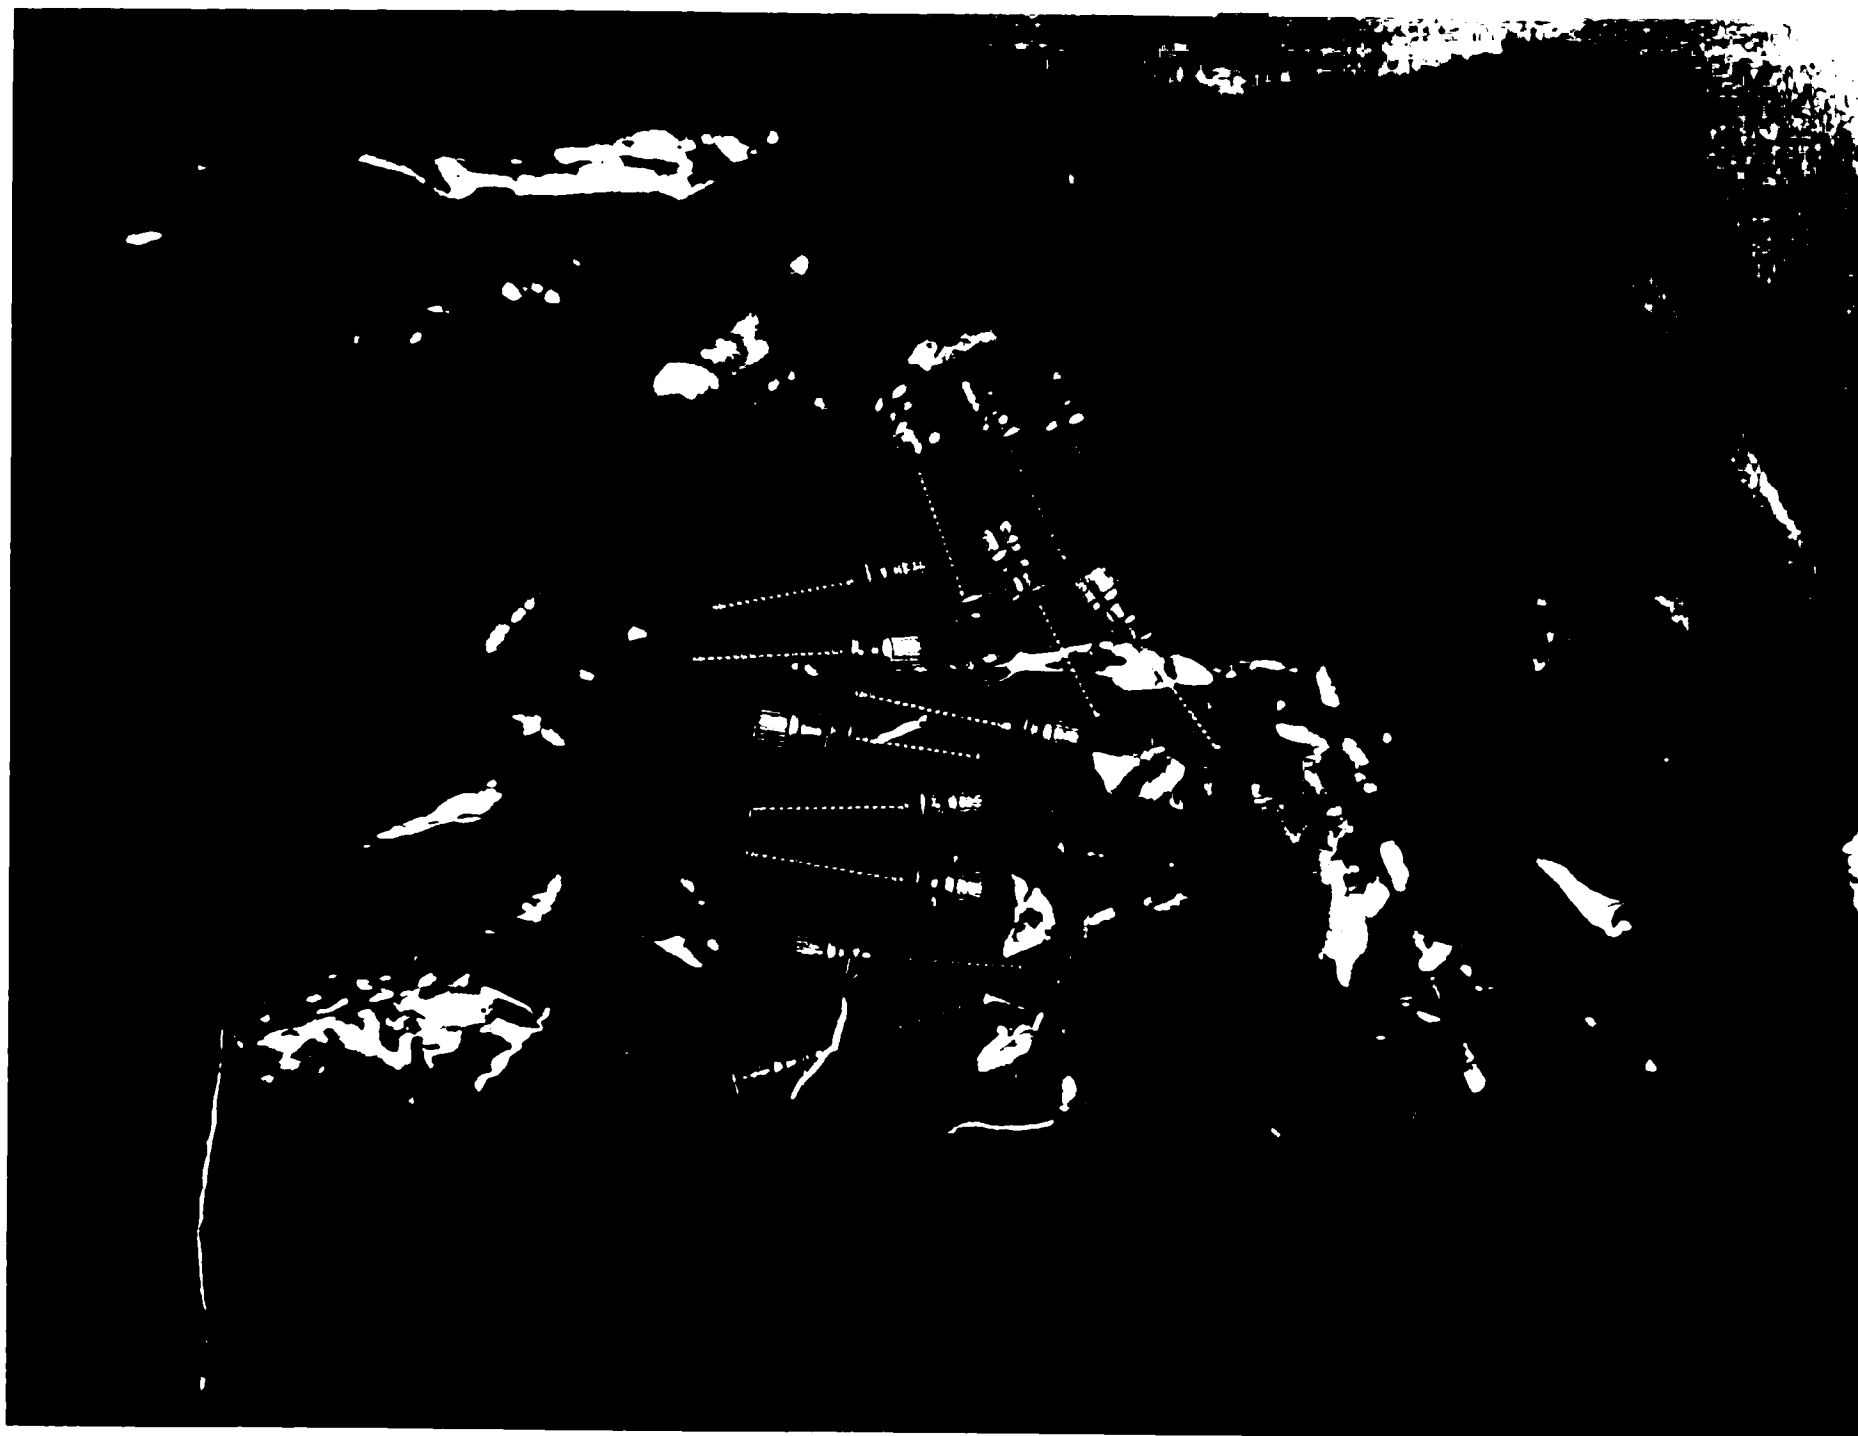

5. Принадлежности для крепления (болты, винты)

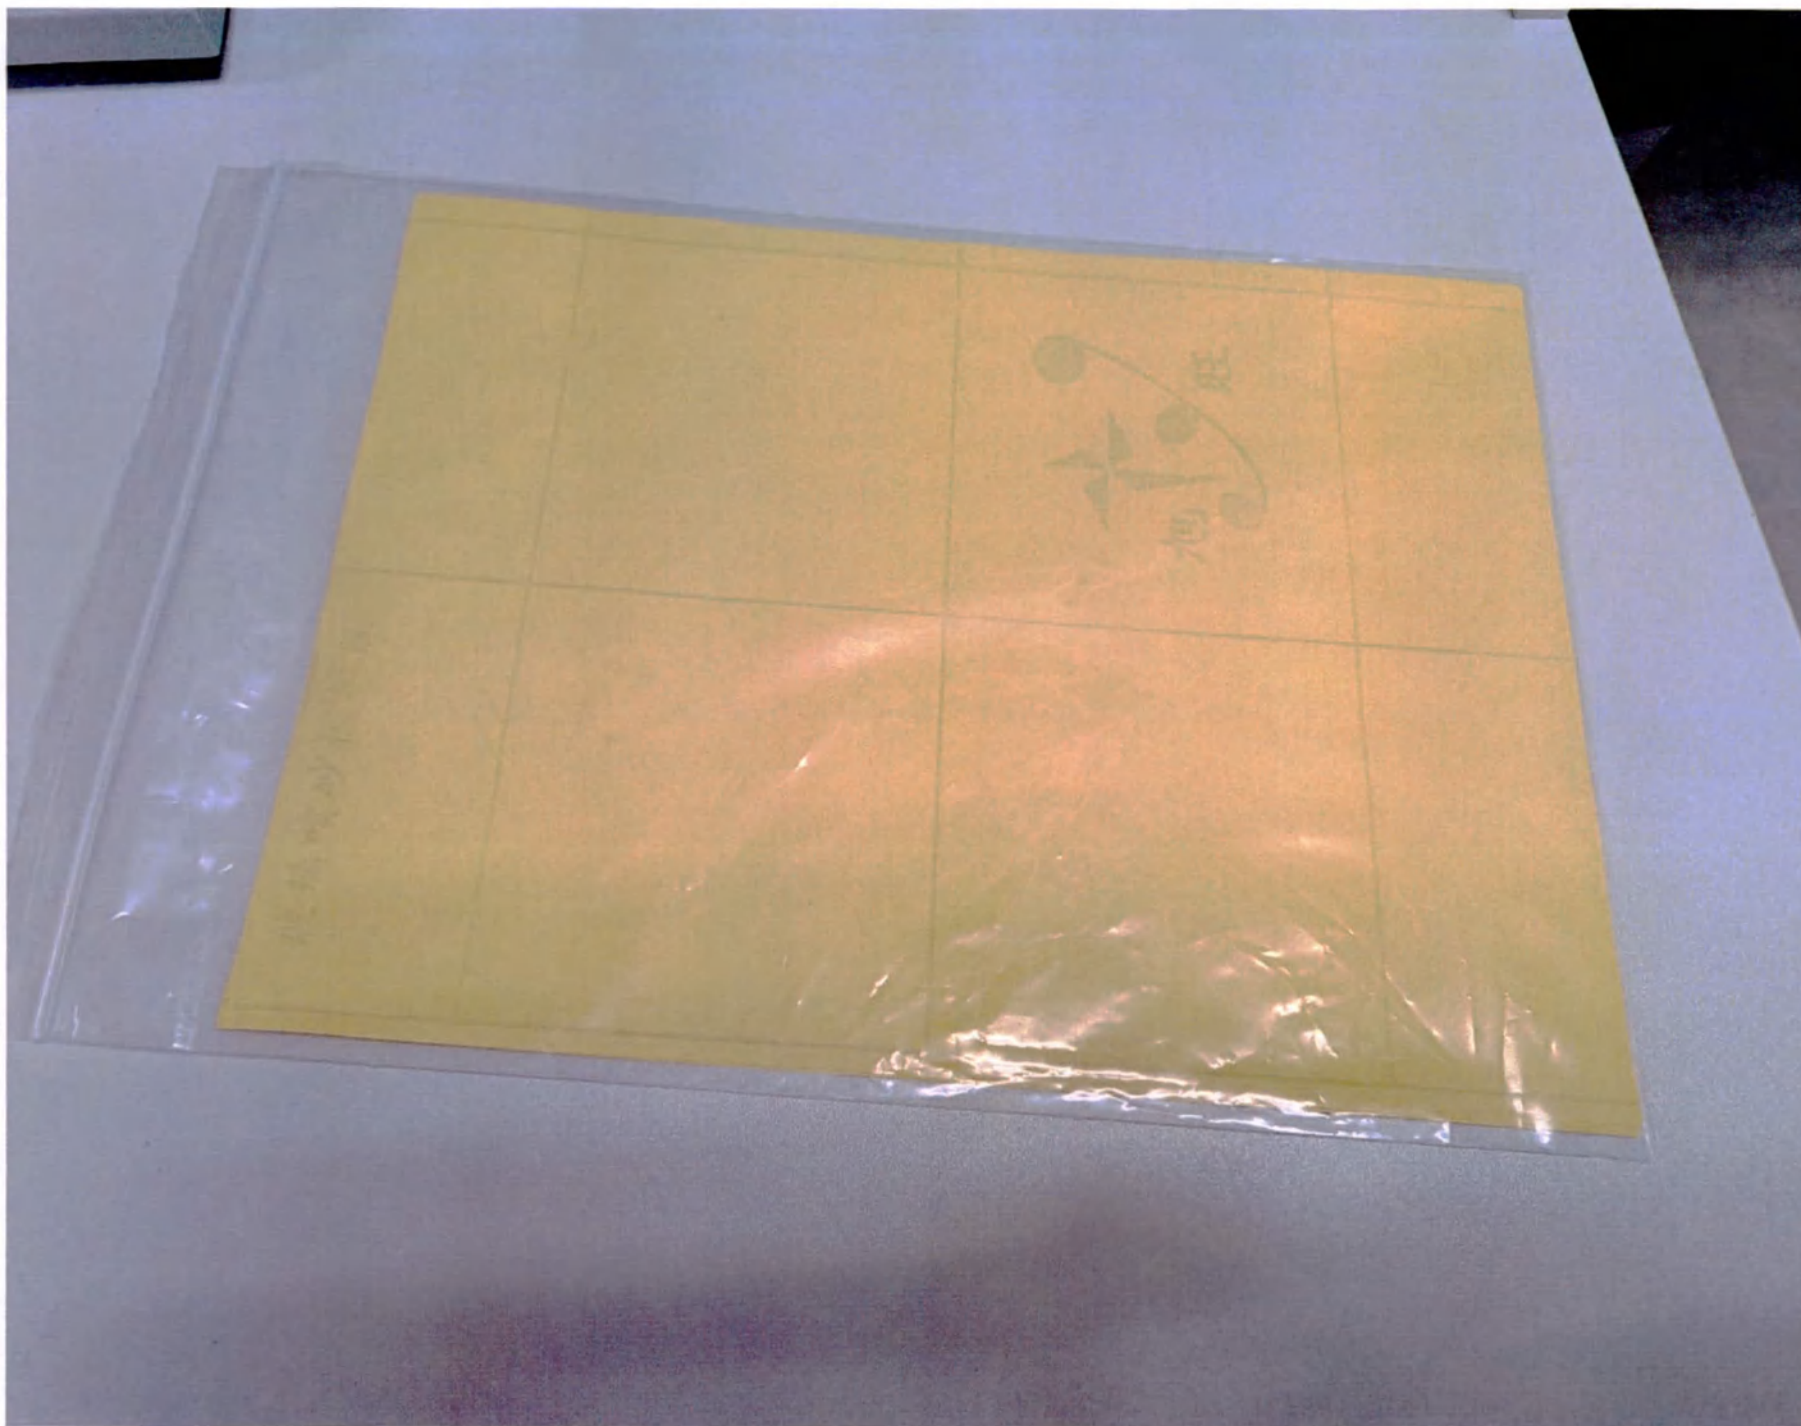

6. Прокладочная бумага (лист)

Макет маркировки изделия

	Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China	
Automatic Luminescence Immunoassay Analyzer		
#	AutoLumo A2000 Plus	
SN	702 100 xxxx	
REF	07021	
Voltage Rating: 230 V ~ Power Rating: 800 VA Frequency: 50/60 Hz		
	yyyy-mm-dd	 
Tel: + 86 - 371- 67985313		IVD

Макет маркировки изделия A2000 Plus на русском языке

**Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
AutoLumo A2000 Plus с принадлежностями**

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Информация о производителе, серийный номер, дата производства
указаны на оригинальной маркировке медицинского изделия

Только для профессионального использования

230 В ~ 800 ВА 50/60 Гц

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации:
ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


Макет маркировки транспортной упаковки A2 Plus

Device Name Automatic Luminescence Immunoassay Analyzer	
#	AutoLumo A2000 Plus
SN	702 100 × × × ×
Package Size	(1635×1130×1465) mm ±10%
Weight	(390 kg+(130) kg) ±10%
 	
 Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China Tel: + 86- 371- 67985313 Website: en.autobio.com.cn	
IVD	This product is used for In Vitro Diagnostic purpose.

Макет маркировки Модуль «Sample delivery management» (SDM)

 Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China	
Sample Delivered Management System	
#	SDM
SN	715 100 xxxx
REF	07150
Voltage Rating: 230 V ~ Power Rating: 800 VA Frequency: 50/60 HZ	
 yyyy-mm-dd	 
Tel: + 86 - 371- 67985313	IVD


Макет маркировки транспортной упаковки Модуль «Sample delivery management» (SDM)

Device Name Sample Delivered Management System	
#	SDM
SN	715 100 × × × ×
Package Size (1353×1027×1217) mm ±10%	
Weight	(155 kg + (121) kg) ±10%
	
 Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China Tel: + 86- 371- 67985313 Website: en.autobio.com.cn	
IVD	This product is used for In Vitro Diagnostic purpose.

Макет маркировки транспортной упаковки Модуль «Sample Transmission Unit» L1 и «Sample Transmission Unit» L2

Module Name Sample Transmission Unit	
SN	715 LINE × × × × ×
Package Size (1523×723×720) mm ±10%	
Weight	(40 kg+(70) kg) ±10%
	
 Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China Tel: + 86- 371- 67985313 Website: en.autobio.com.cn	
IVD	This product is used for In Vitro Diagnostic purpose.

Макет маркировки транспортной упаковки Пробозаборник для режима параллельной работы «SCARA»

Module Name Folding Arms(SCARA)	
SN	702 SCARA ××××
Package Size	(510×445×390) mm±10%
Weight	(6 kg+(1.5) kg) ±10%
	
	Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China Tel: + 86- 371- 67985313 Website: en.autobio.com.cn
IVD	This product is used for In Vitro Diagnostic purpose.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 07

шестьдесят семь листах

