



Общество с ограниченной ответственностью
«Азиямедконсалт»
Россия, 109004, Москва, ул. А. Солженицына, д. 27
Тел.: +7 495 988 47 44
ОГРН: 1137746433879
ИНН: 7709929540

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»




Перцева Н. Н.

«21» августа 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x250 мл.

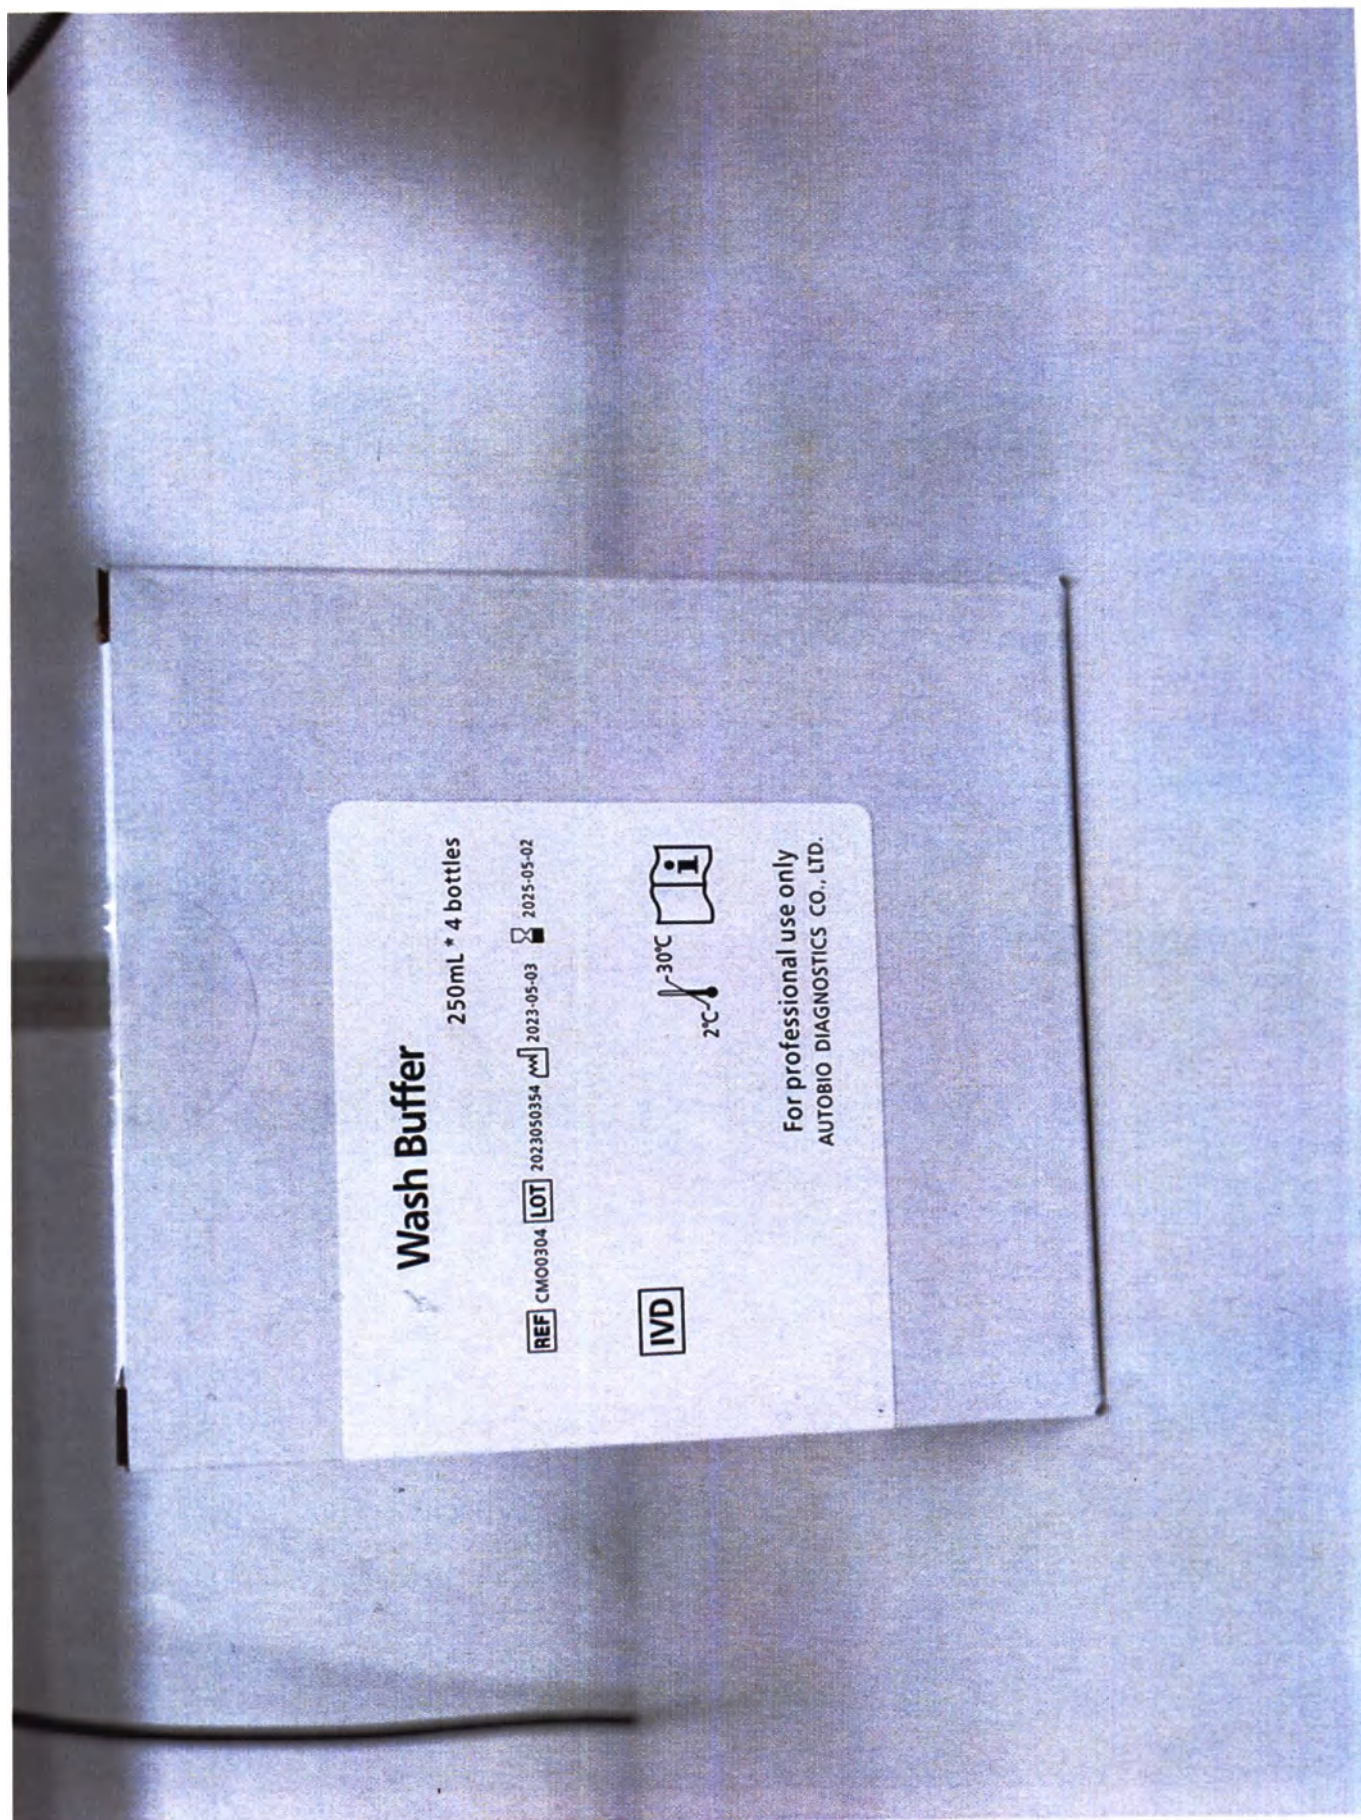

Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней паковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x250 мл.

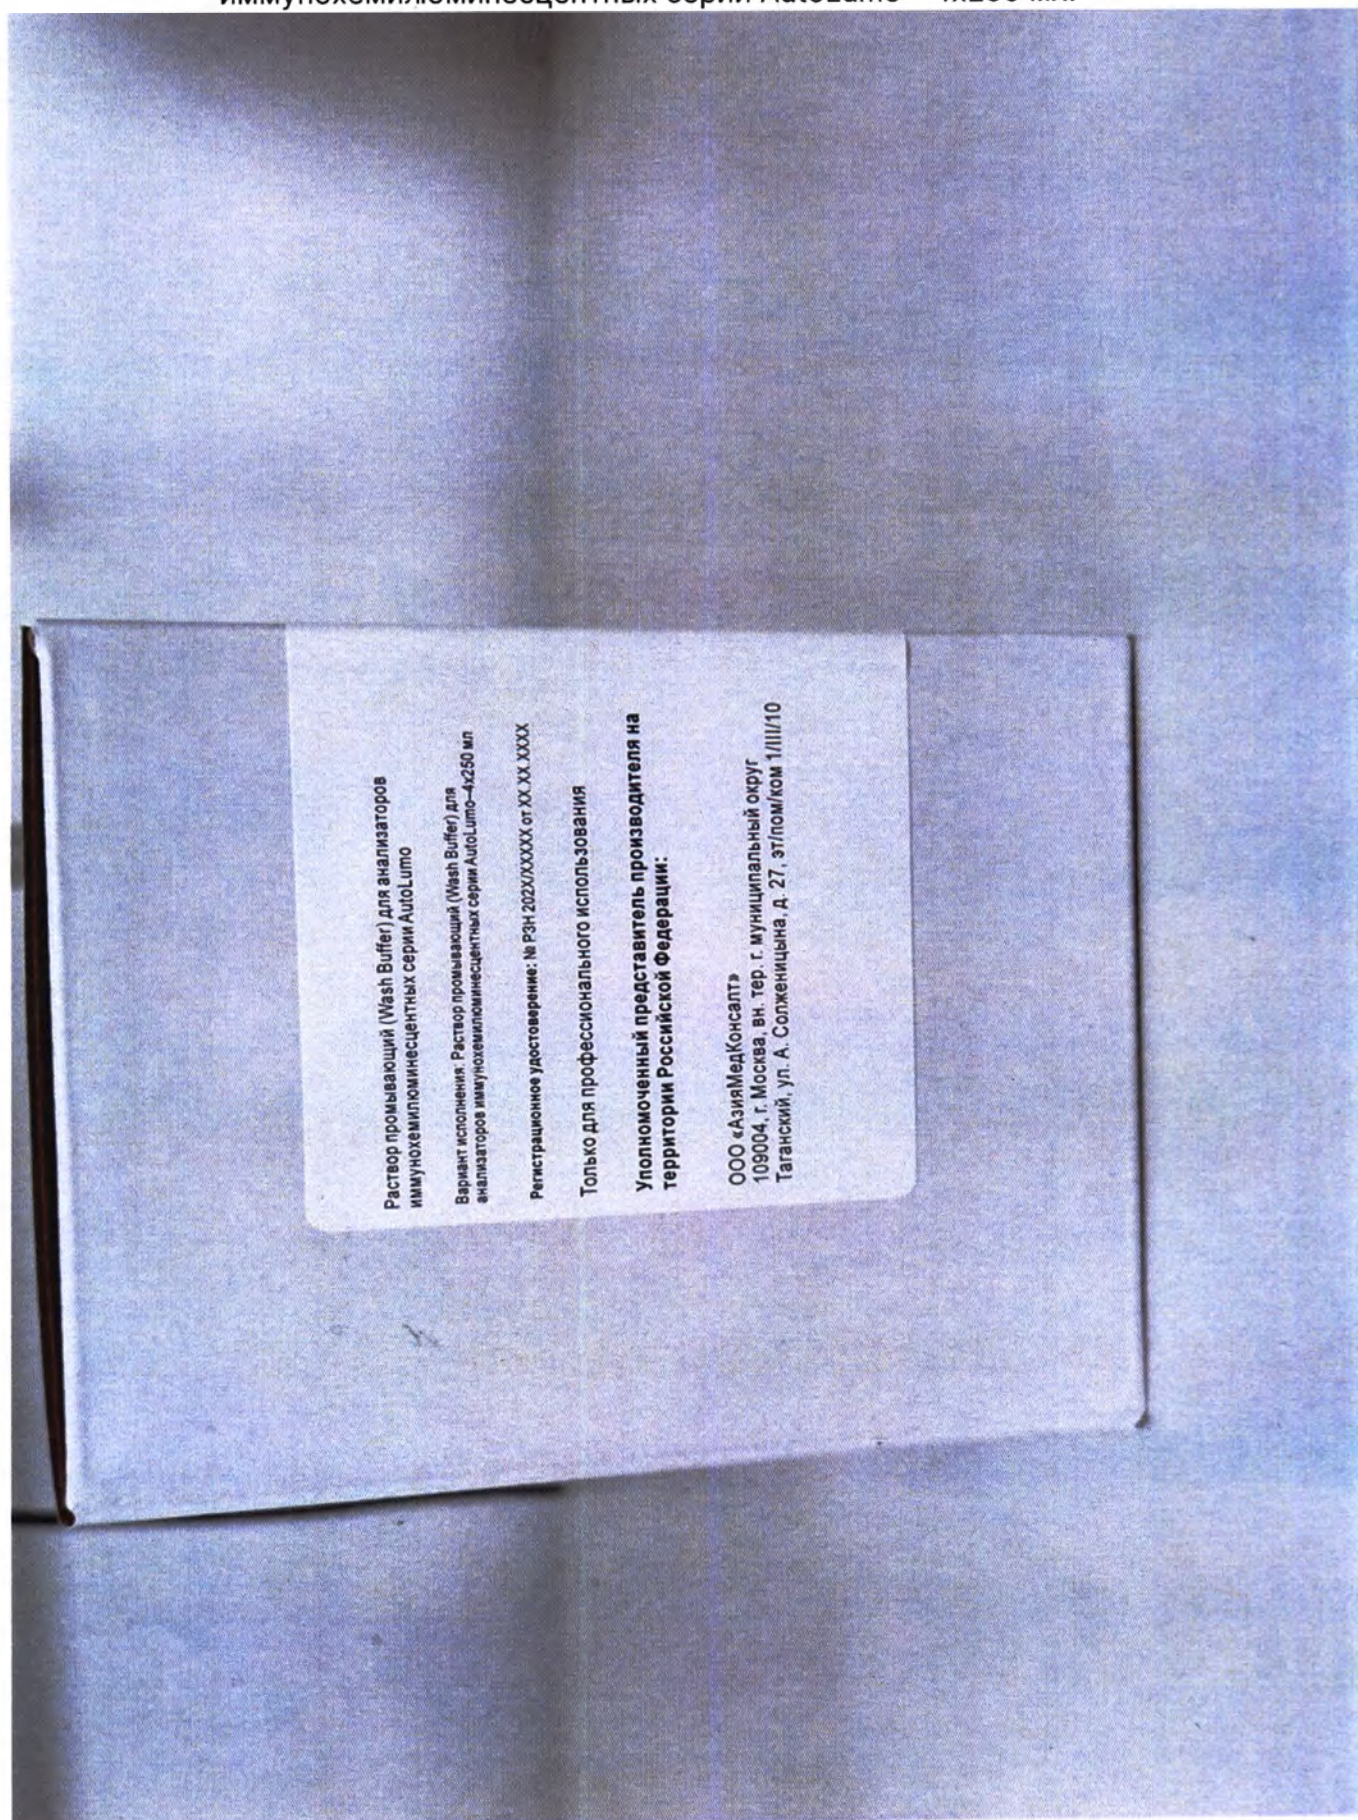

Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo—4x250 мл


Регистрационное удостоверение: № РЗН 2020/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский ул. А. Сопженицына д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x250 мл.

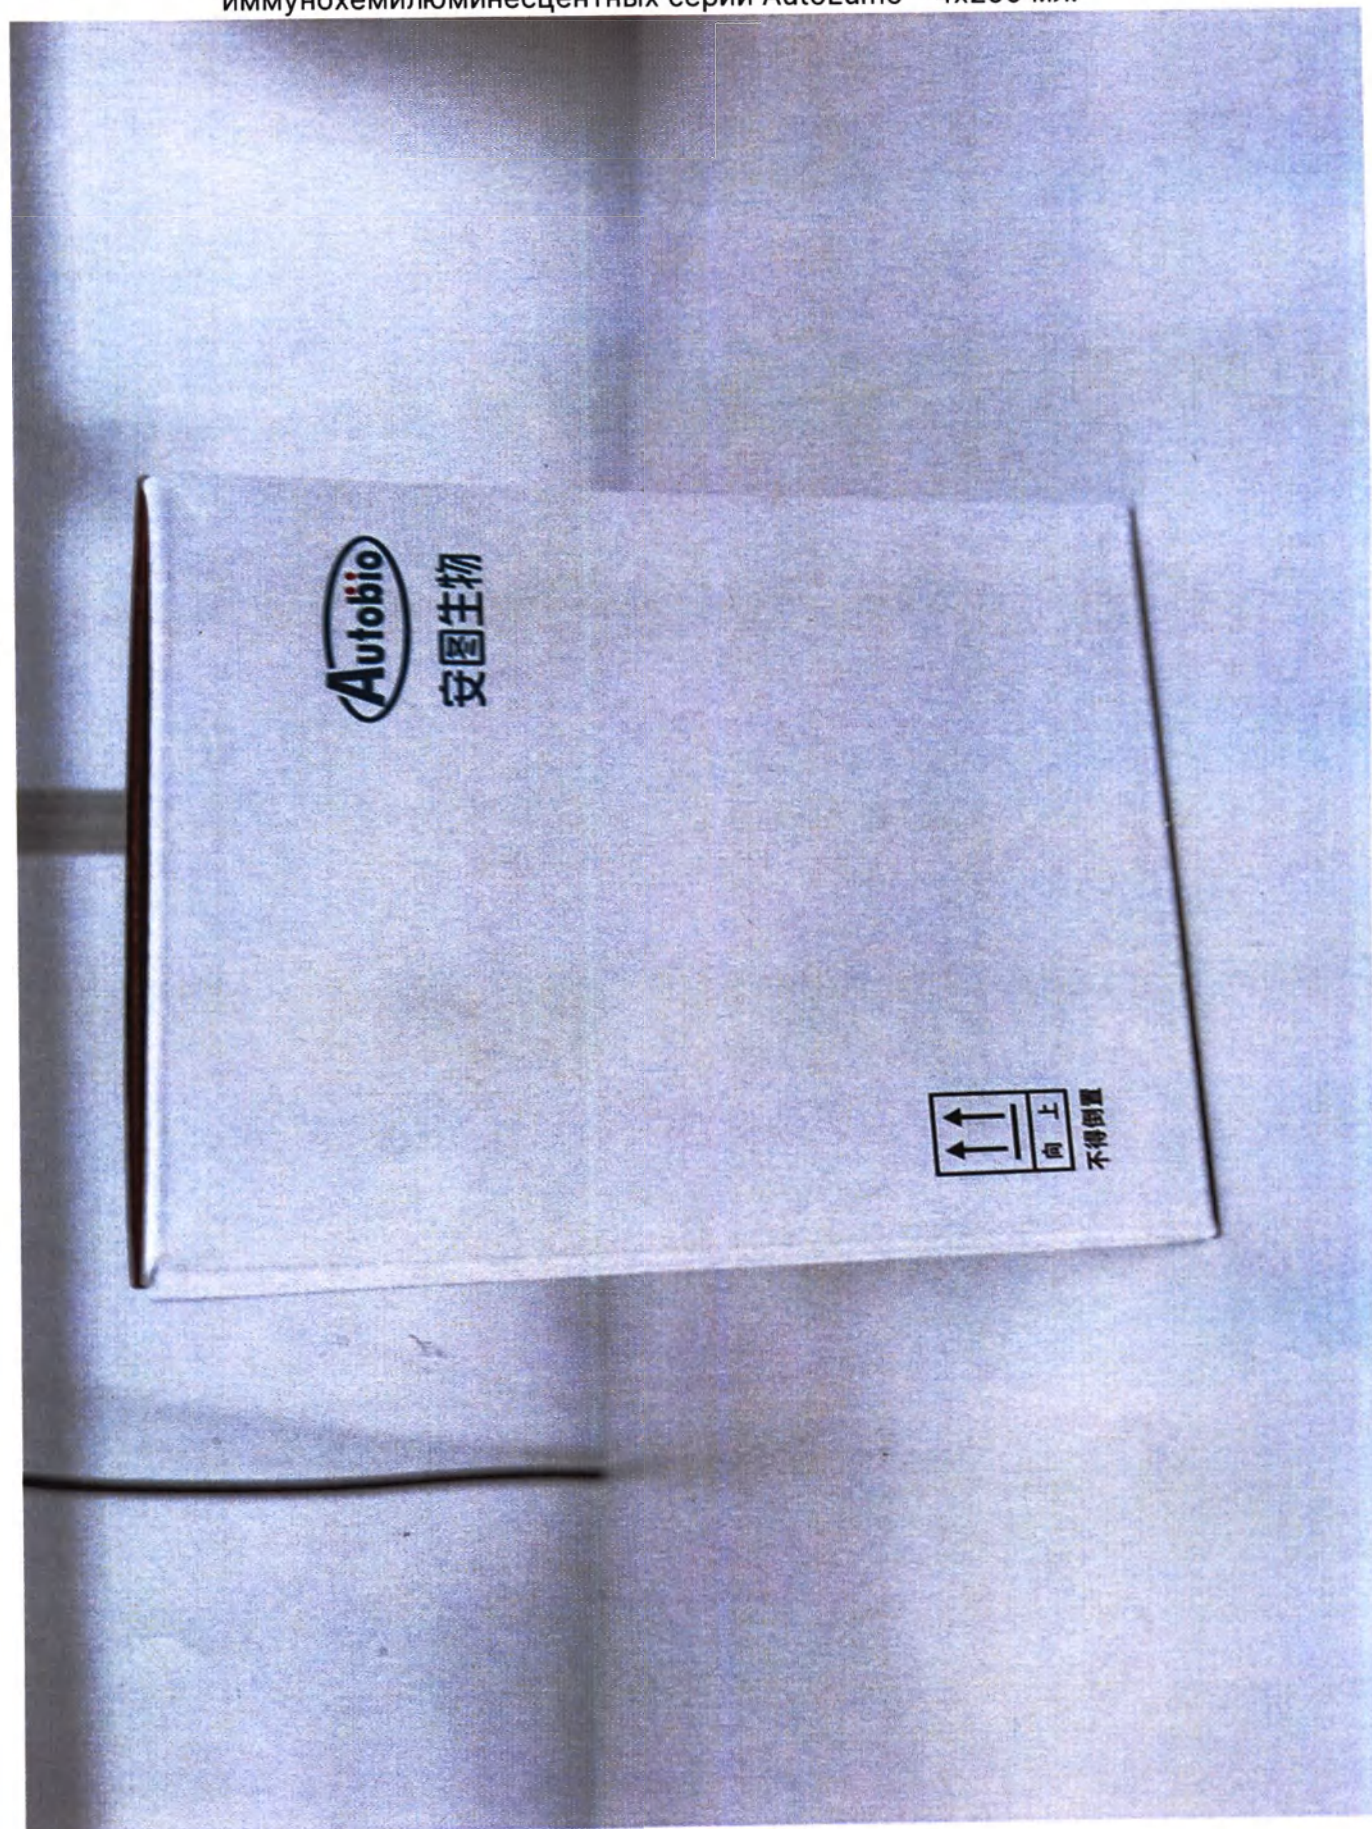

Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x250 мл.




Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x500 мл.

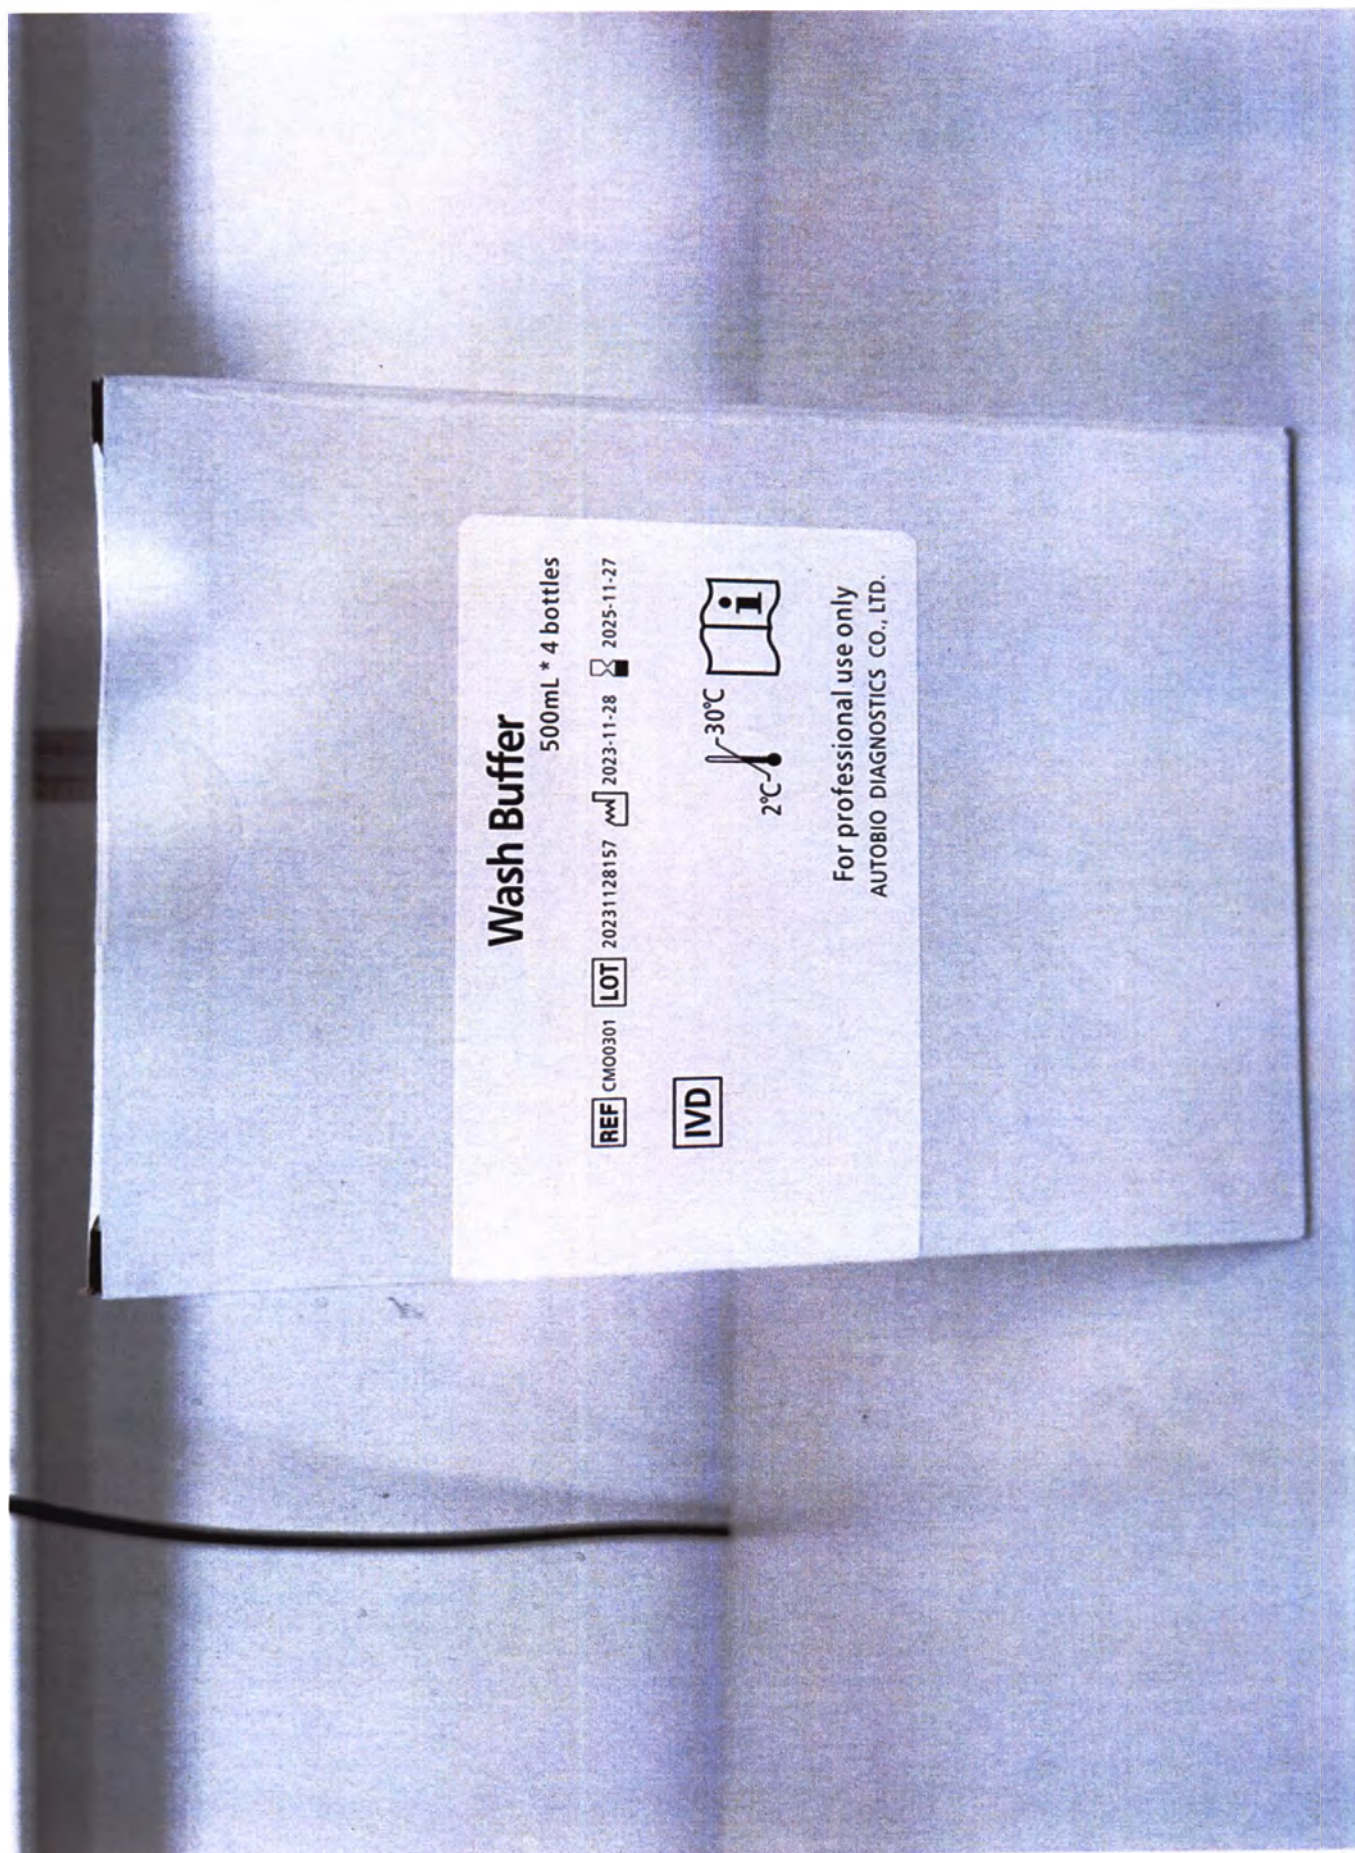


Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x500 мл.

Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo
Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для
анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo-4x500 мл
Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXX от XX.XX.XXXX
Только для профессионального использования
Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:
ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x500 мл.

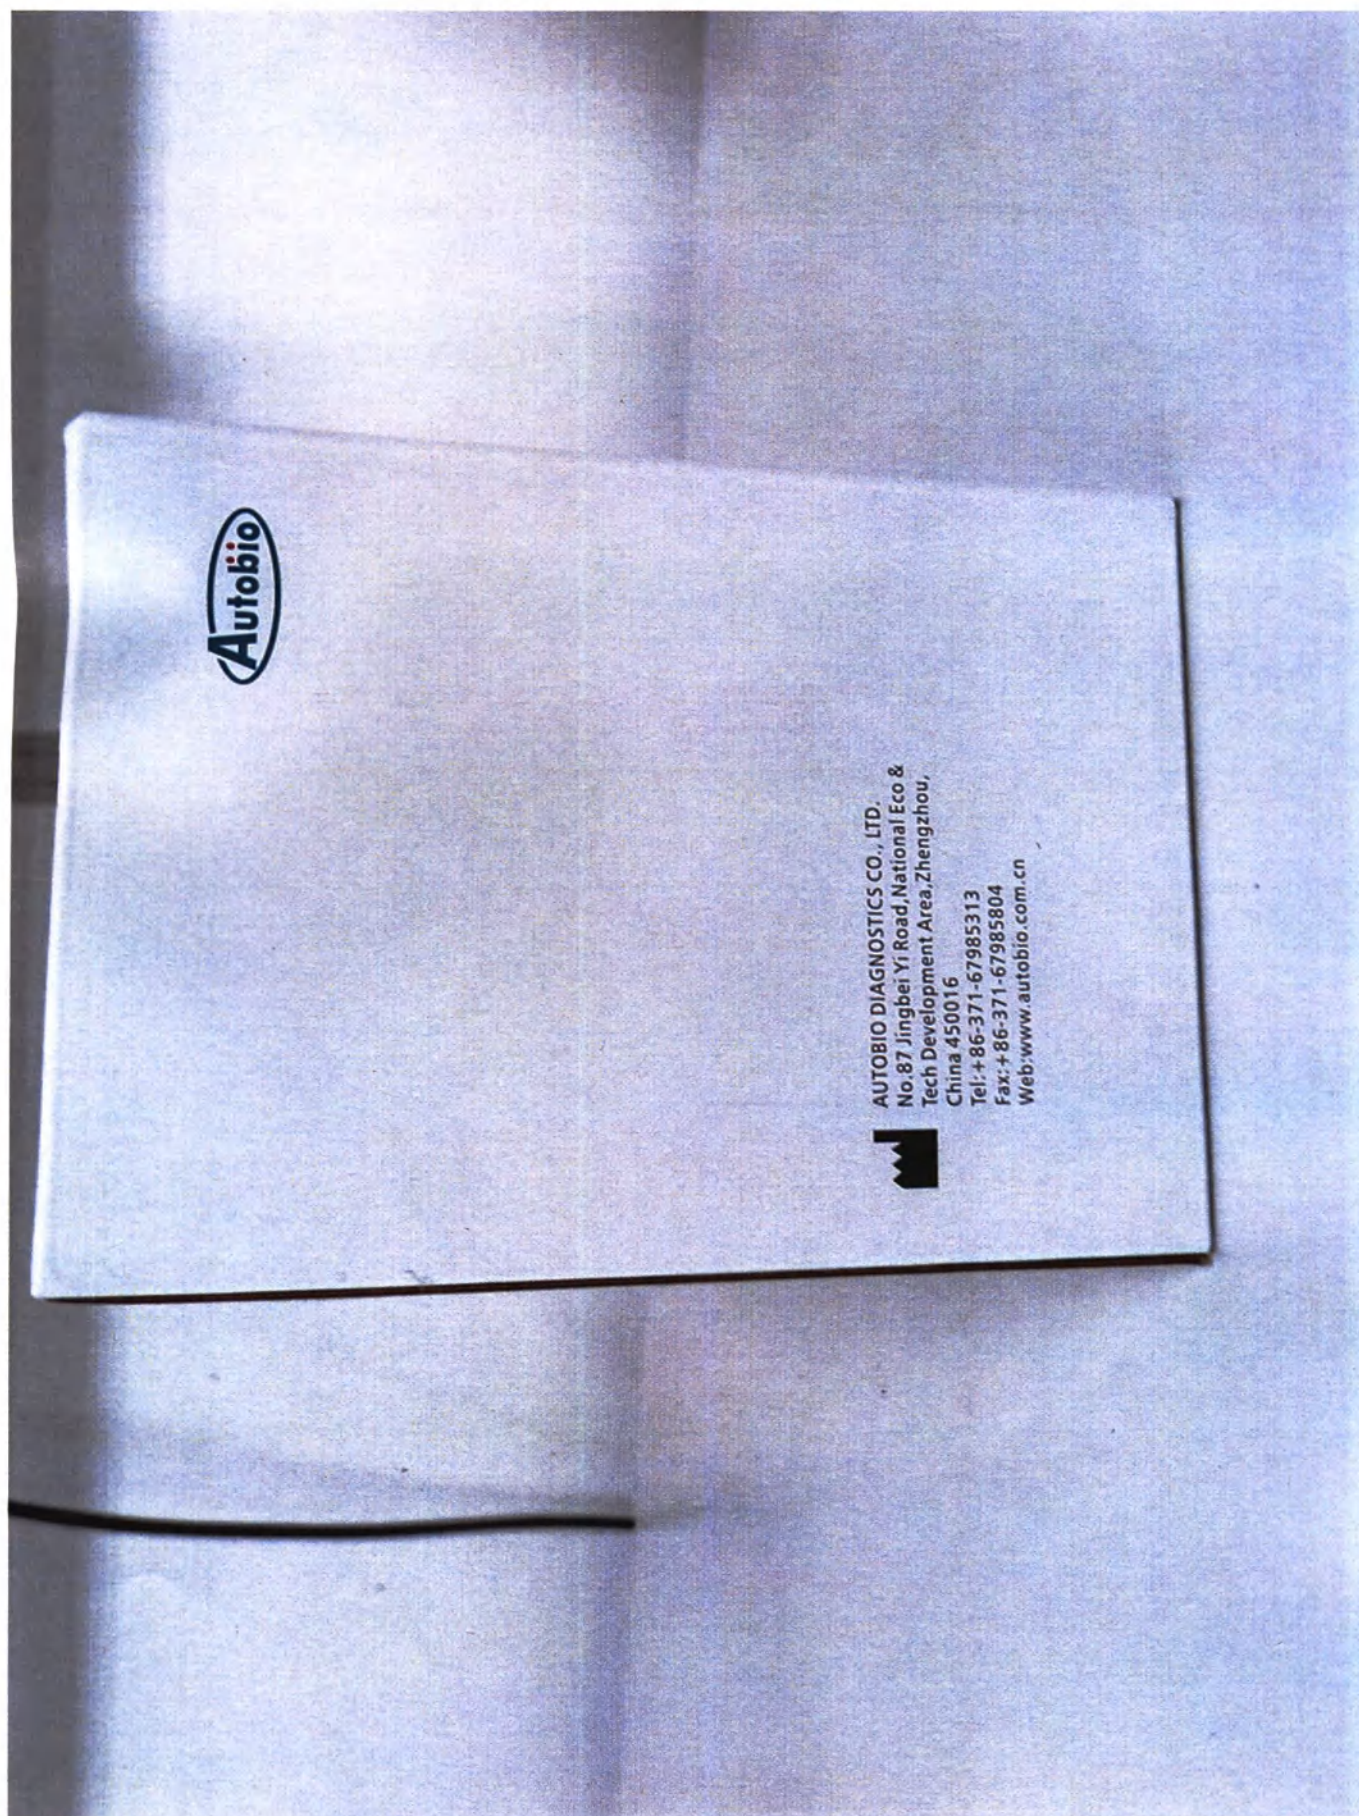


Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) до вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x500 мл.

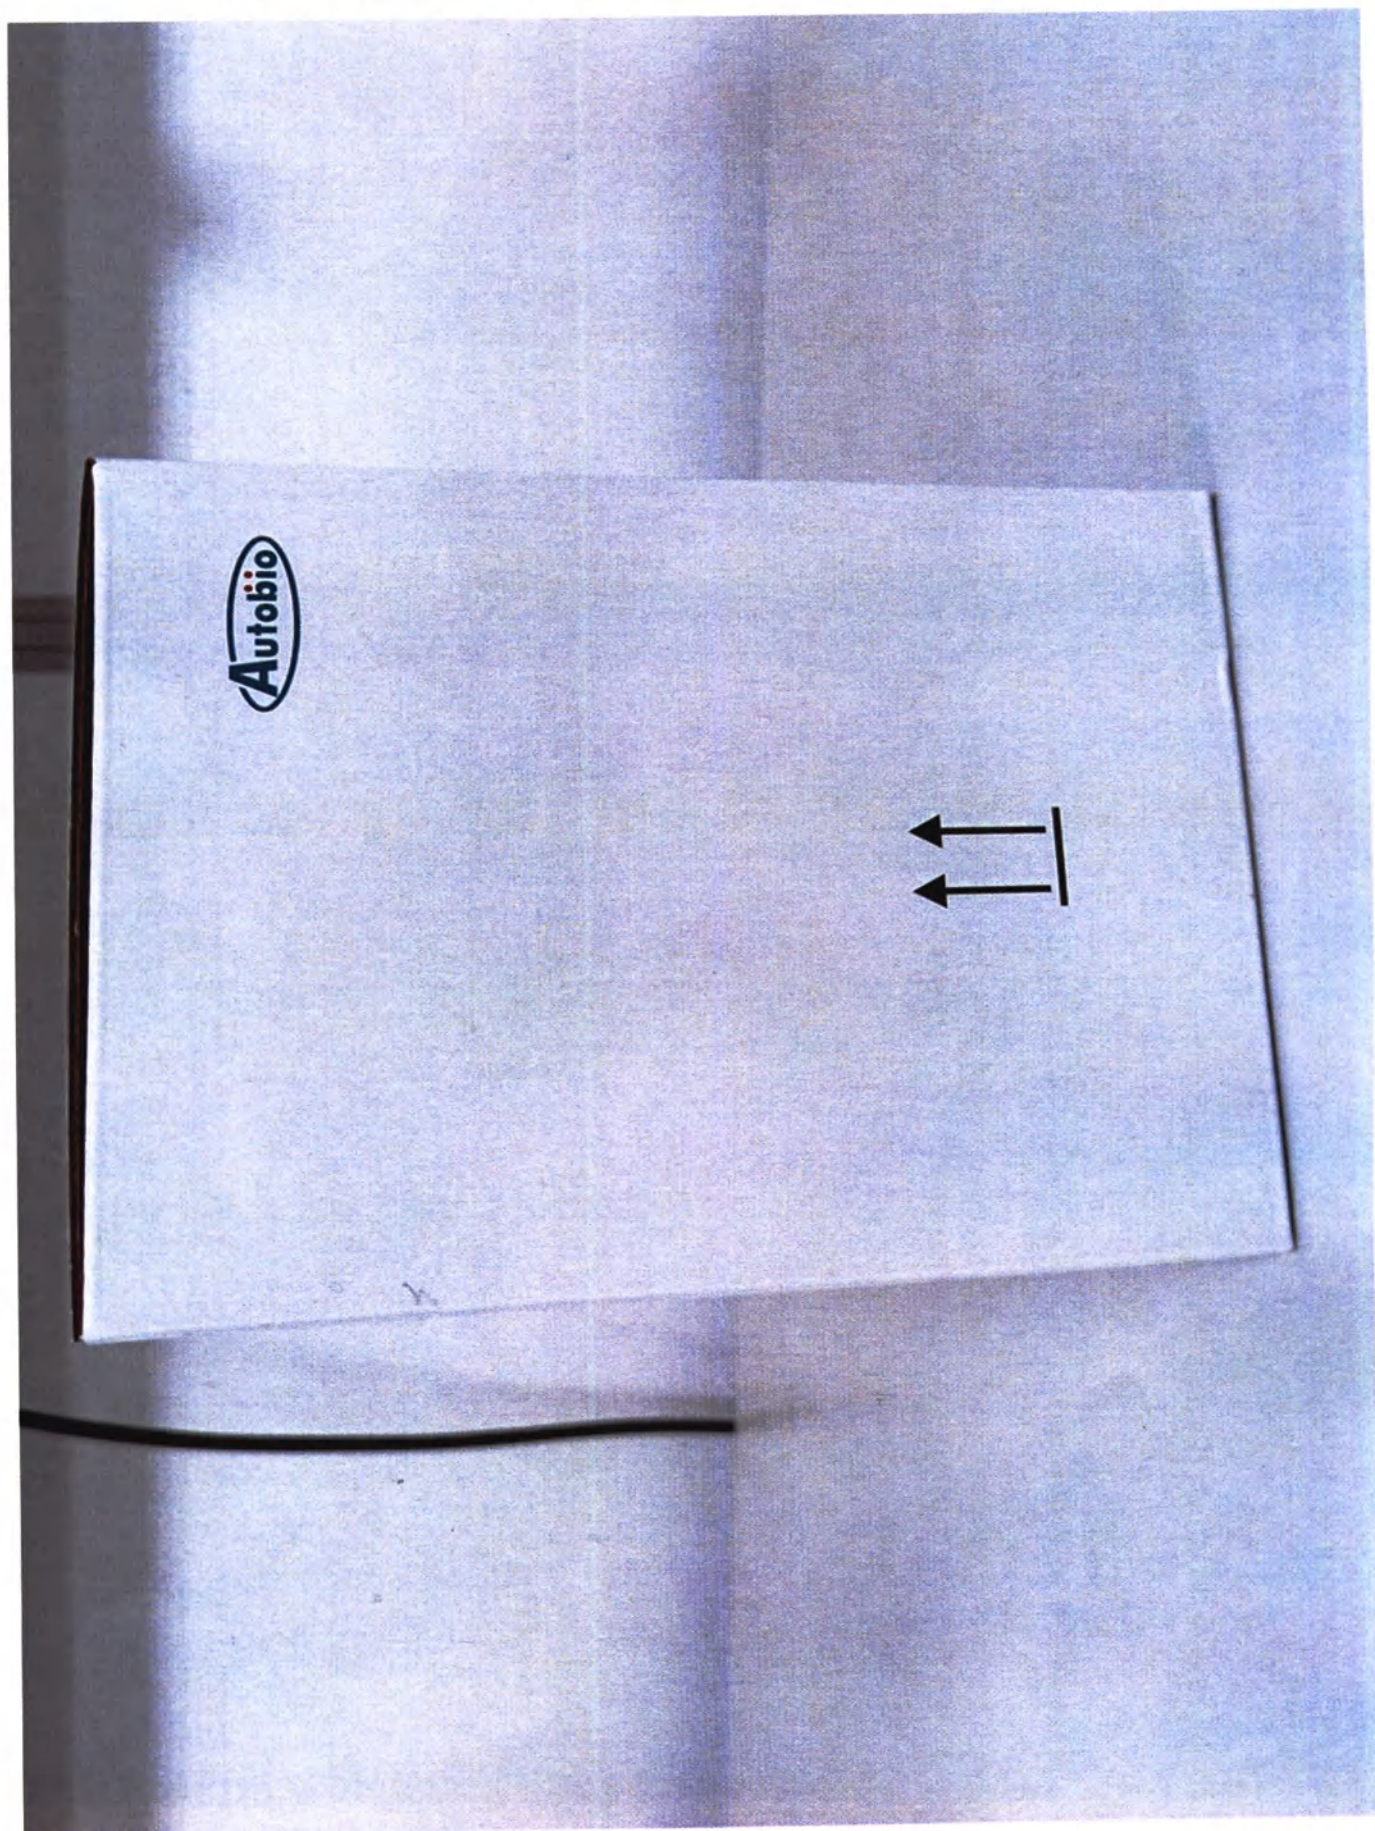

Фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) после вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x250 мл.

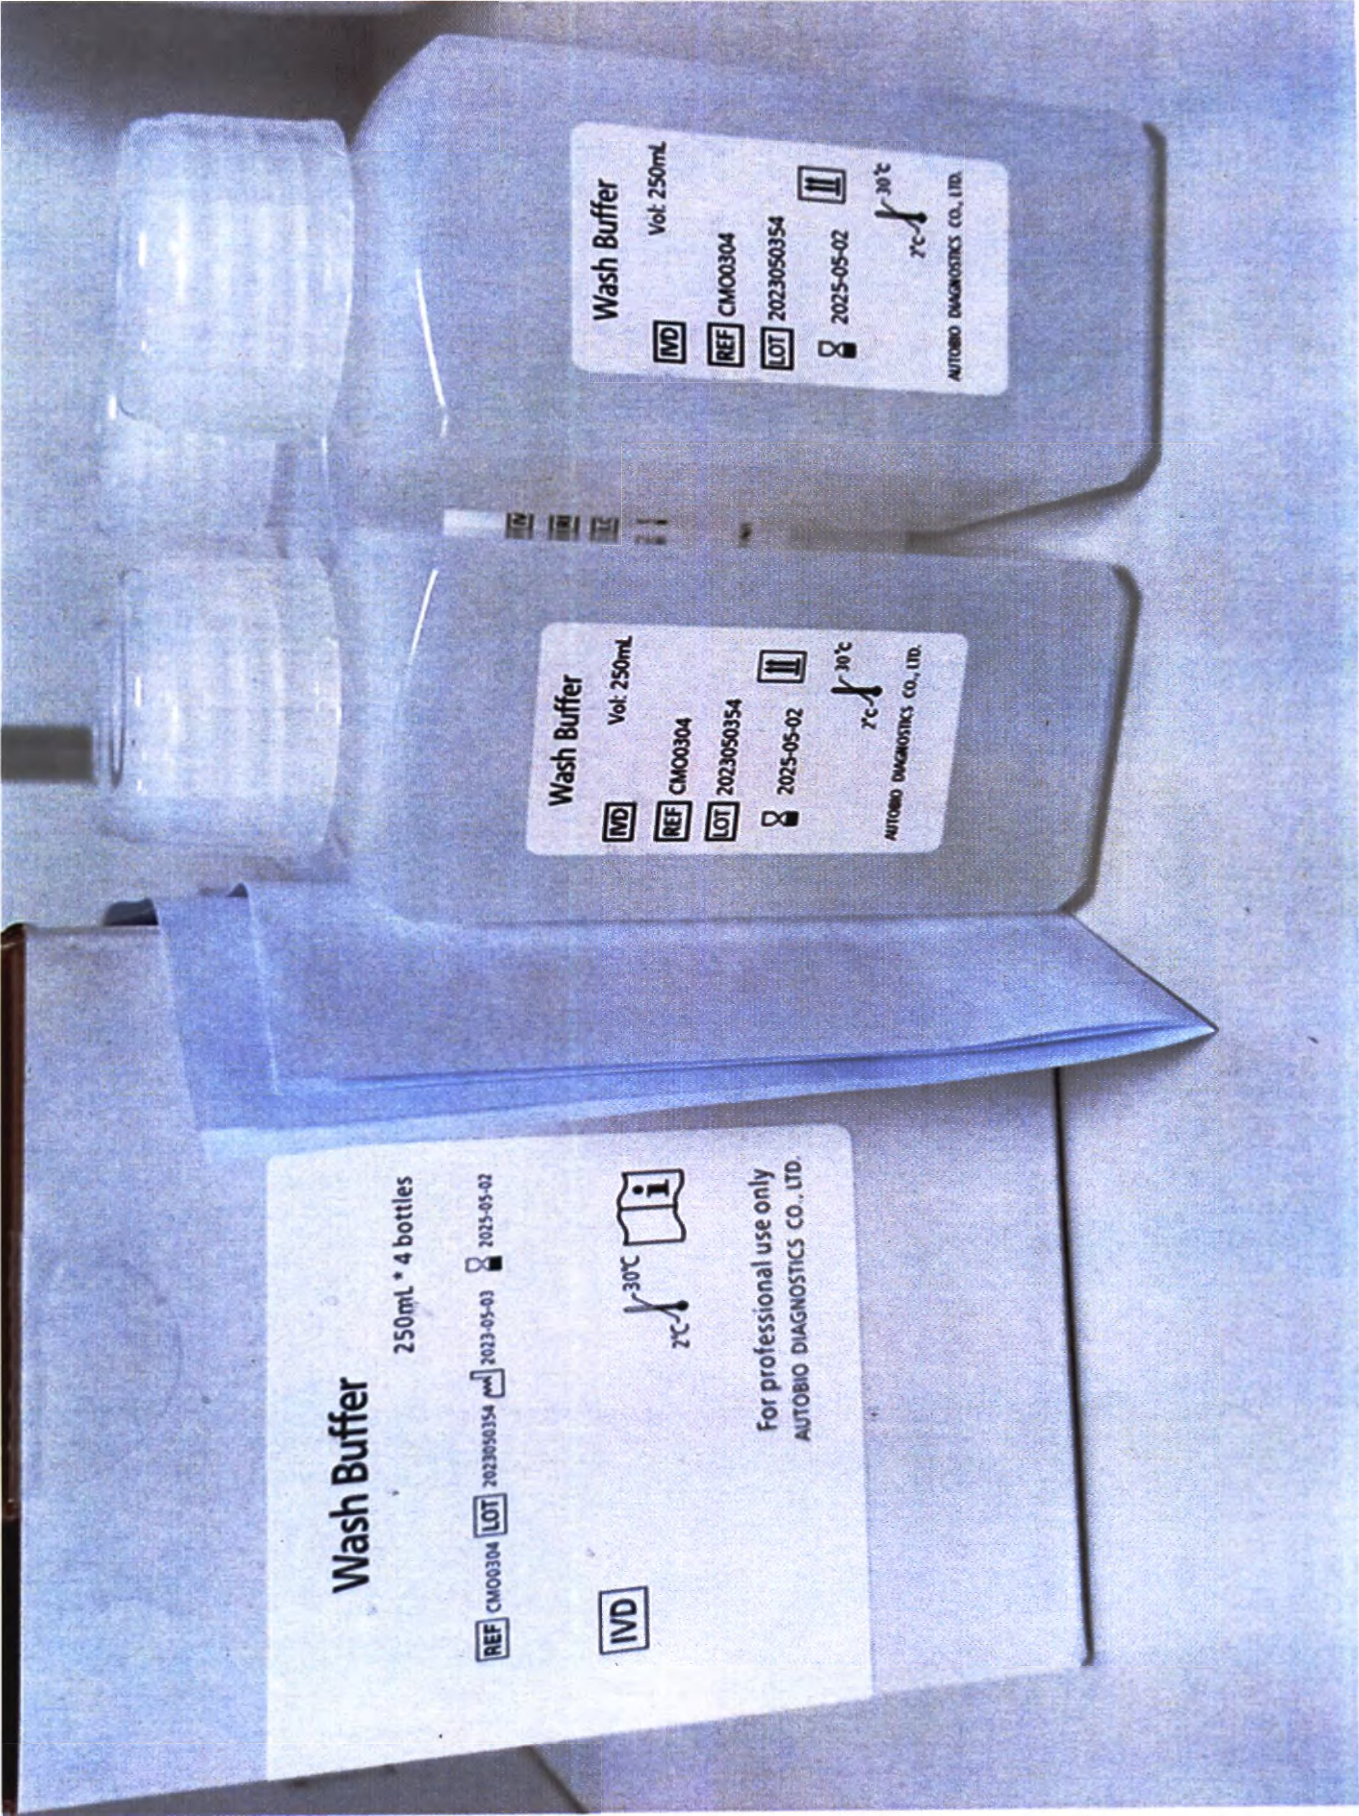

фотографическое изображение раствора промывающего (Wash Buffer) после вскрытия внешней упаковки (коробка), Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x500 мл.

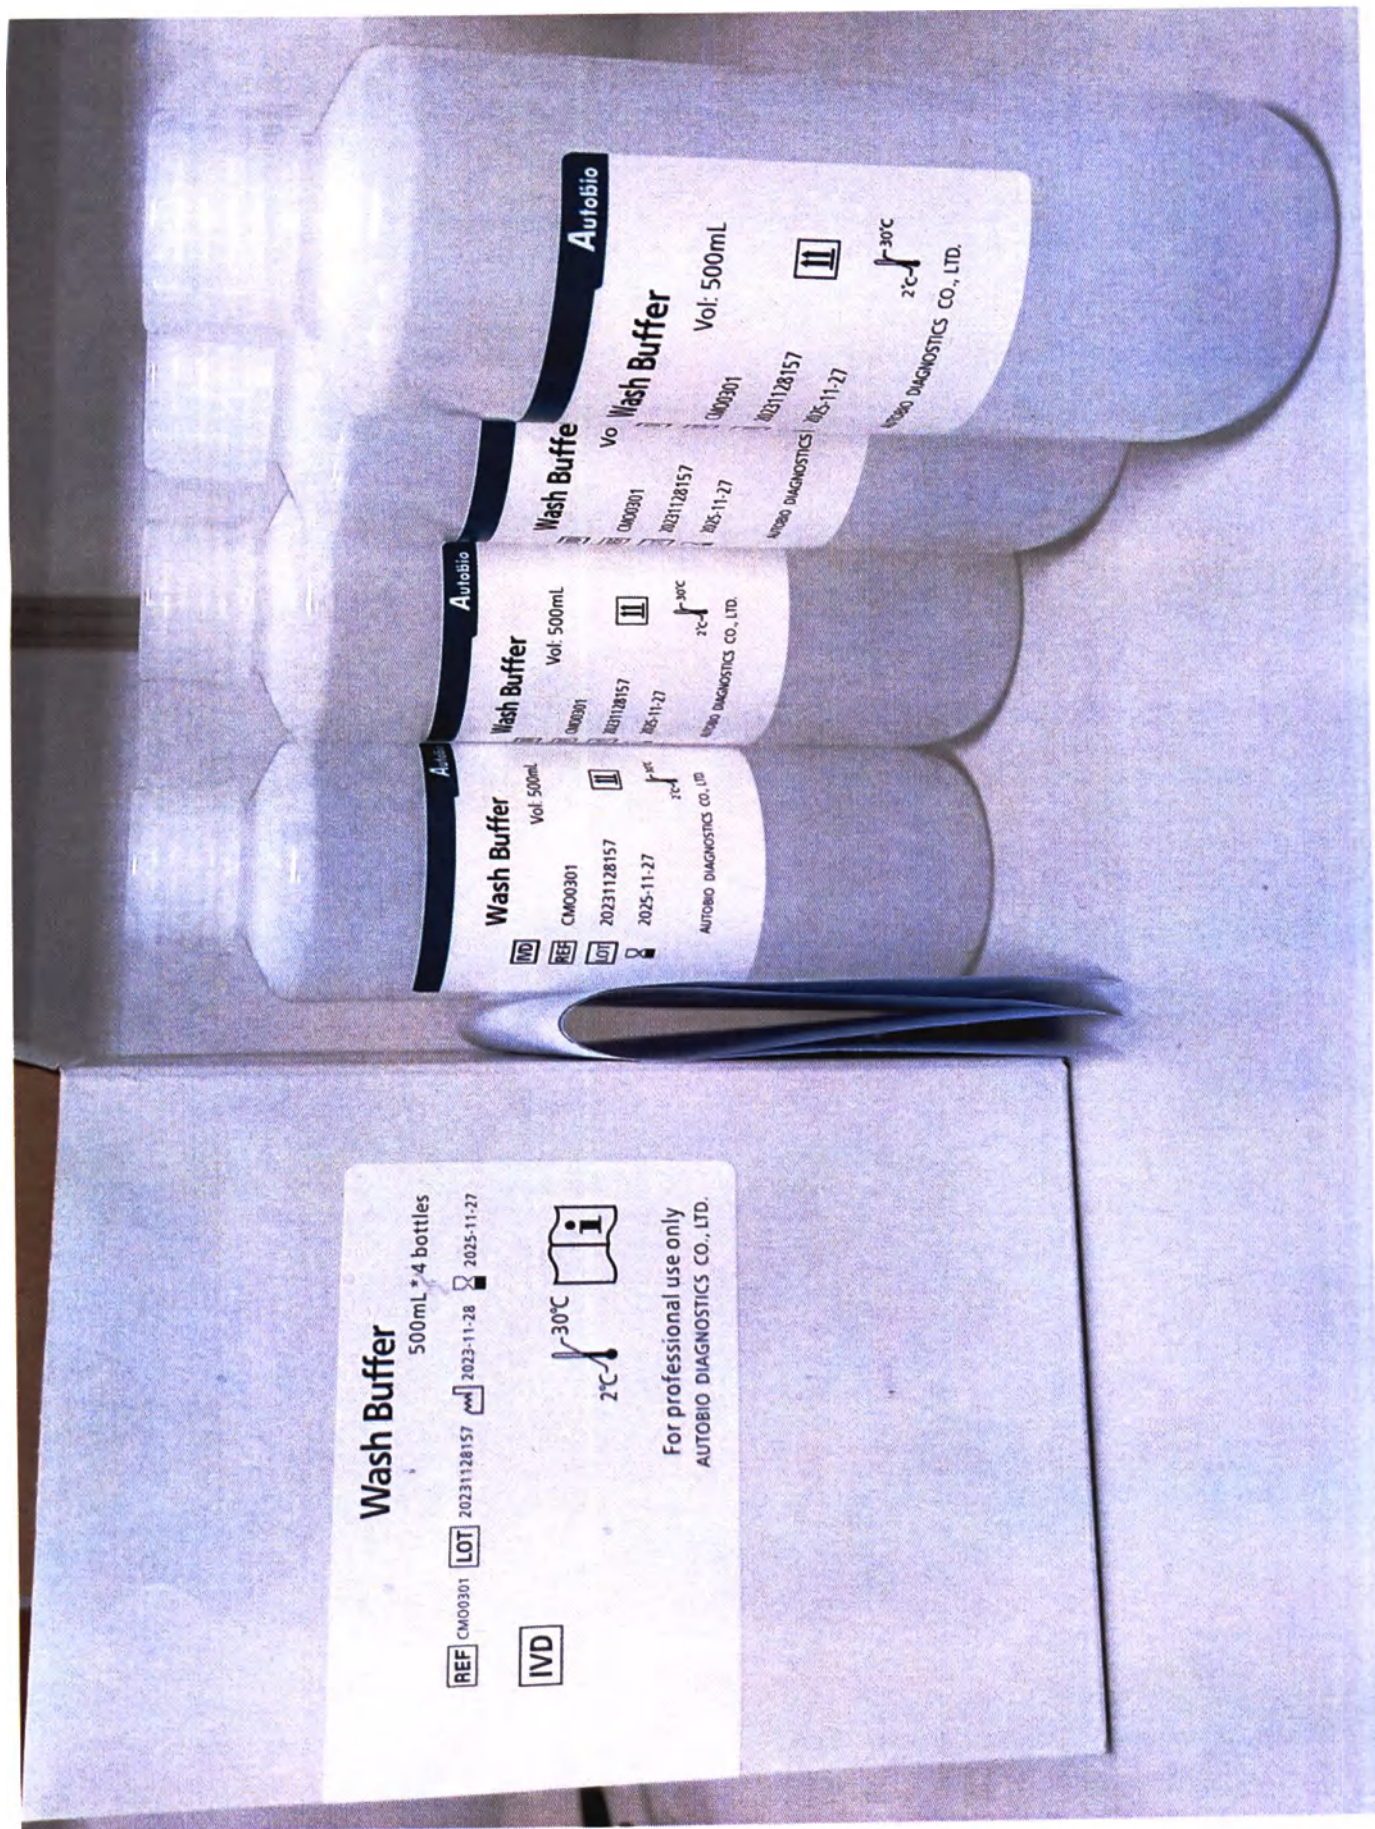

Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Фотографическое изображение макета маркировки медицинского изделия, вариант исполнения:
Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии
AutoLumo – 4x500 мл

Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo–4x500 мл

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Wash Buffer

500mL * 4 bottles


REF

CMO0301

LOT

IVD





For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Фотографическое изображение макета маркировки медицинского изделия, вариант исполнения:
Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии
AutoLumo – 4x250 мл

Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo–4x250 мл

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Wash Buffer

250mL * 4 bottles


REF

CMO0304

LOT

IVD





For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Маркет маркировки флакона, варианта исполнения: раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x500 мл

AutoBio

Wash Buffer

IVD

Vol: 500mL


REF

CMO0301

LOT







AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Маркет маркировки флакона, варианта исполнения: раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo – 4x250 мл

Wash Buffer

Vol: 250mL

IVD


REF

CMO0304

LOT







AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14

(сетовидности)

листах

