

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»




Н.Н. Перцева


«26» августа 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор хемилюминесцентных субстратов (Chemiluminescent Substrate) для
анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка
110 мл*2 шт

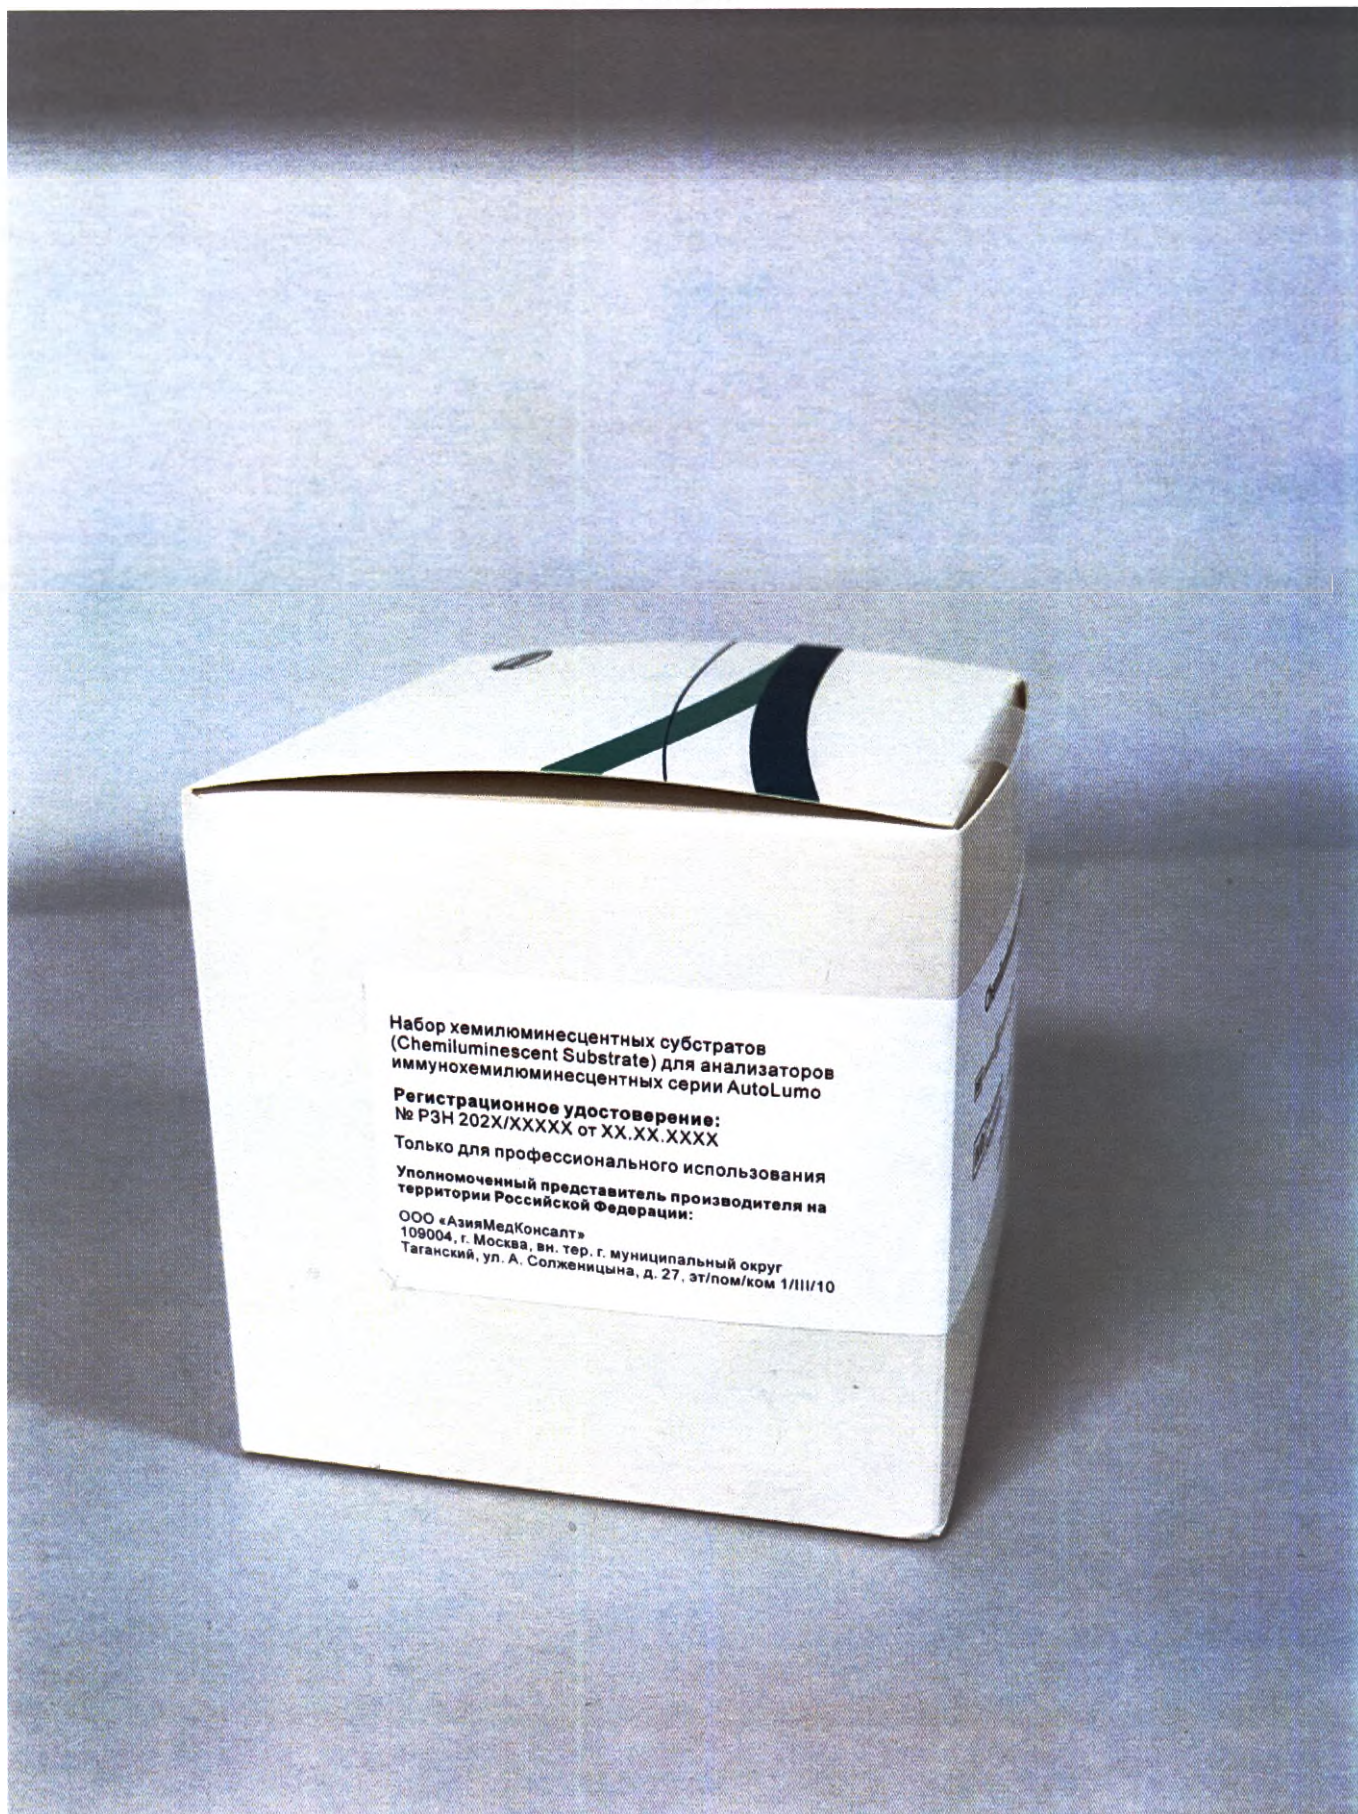

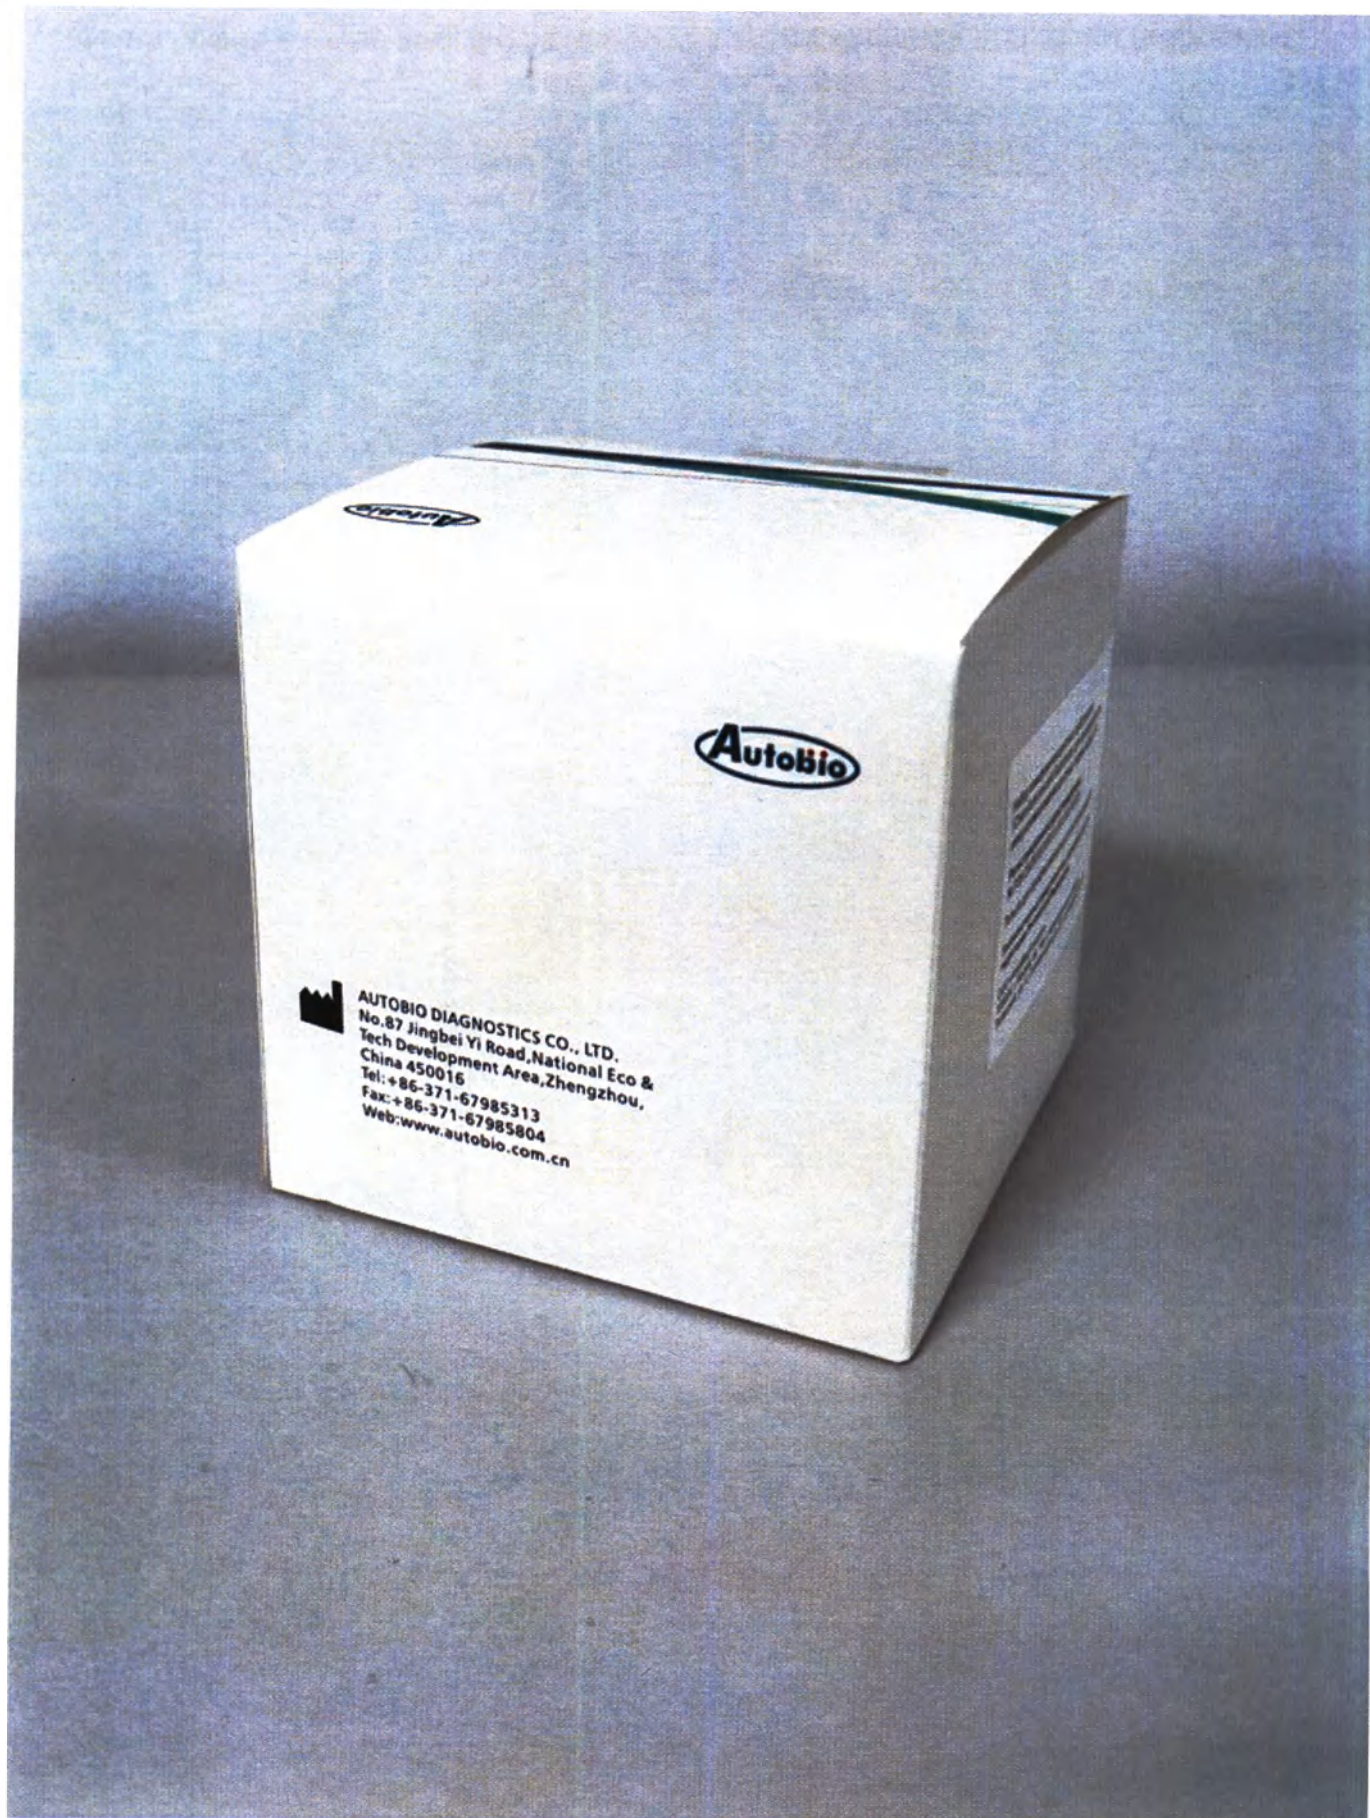

 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No.87 Jingbei Yi Road, National Eco &
Tech Development Area, Zhengzhou,
China 450016
Tel: +86-371-67985313
Fax: +86-371-67985804
Web: www.autobio.com.cn

Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 110 мл*2 шт

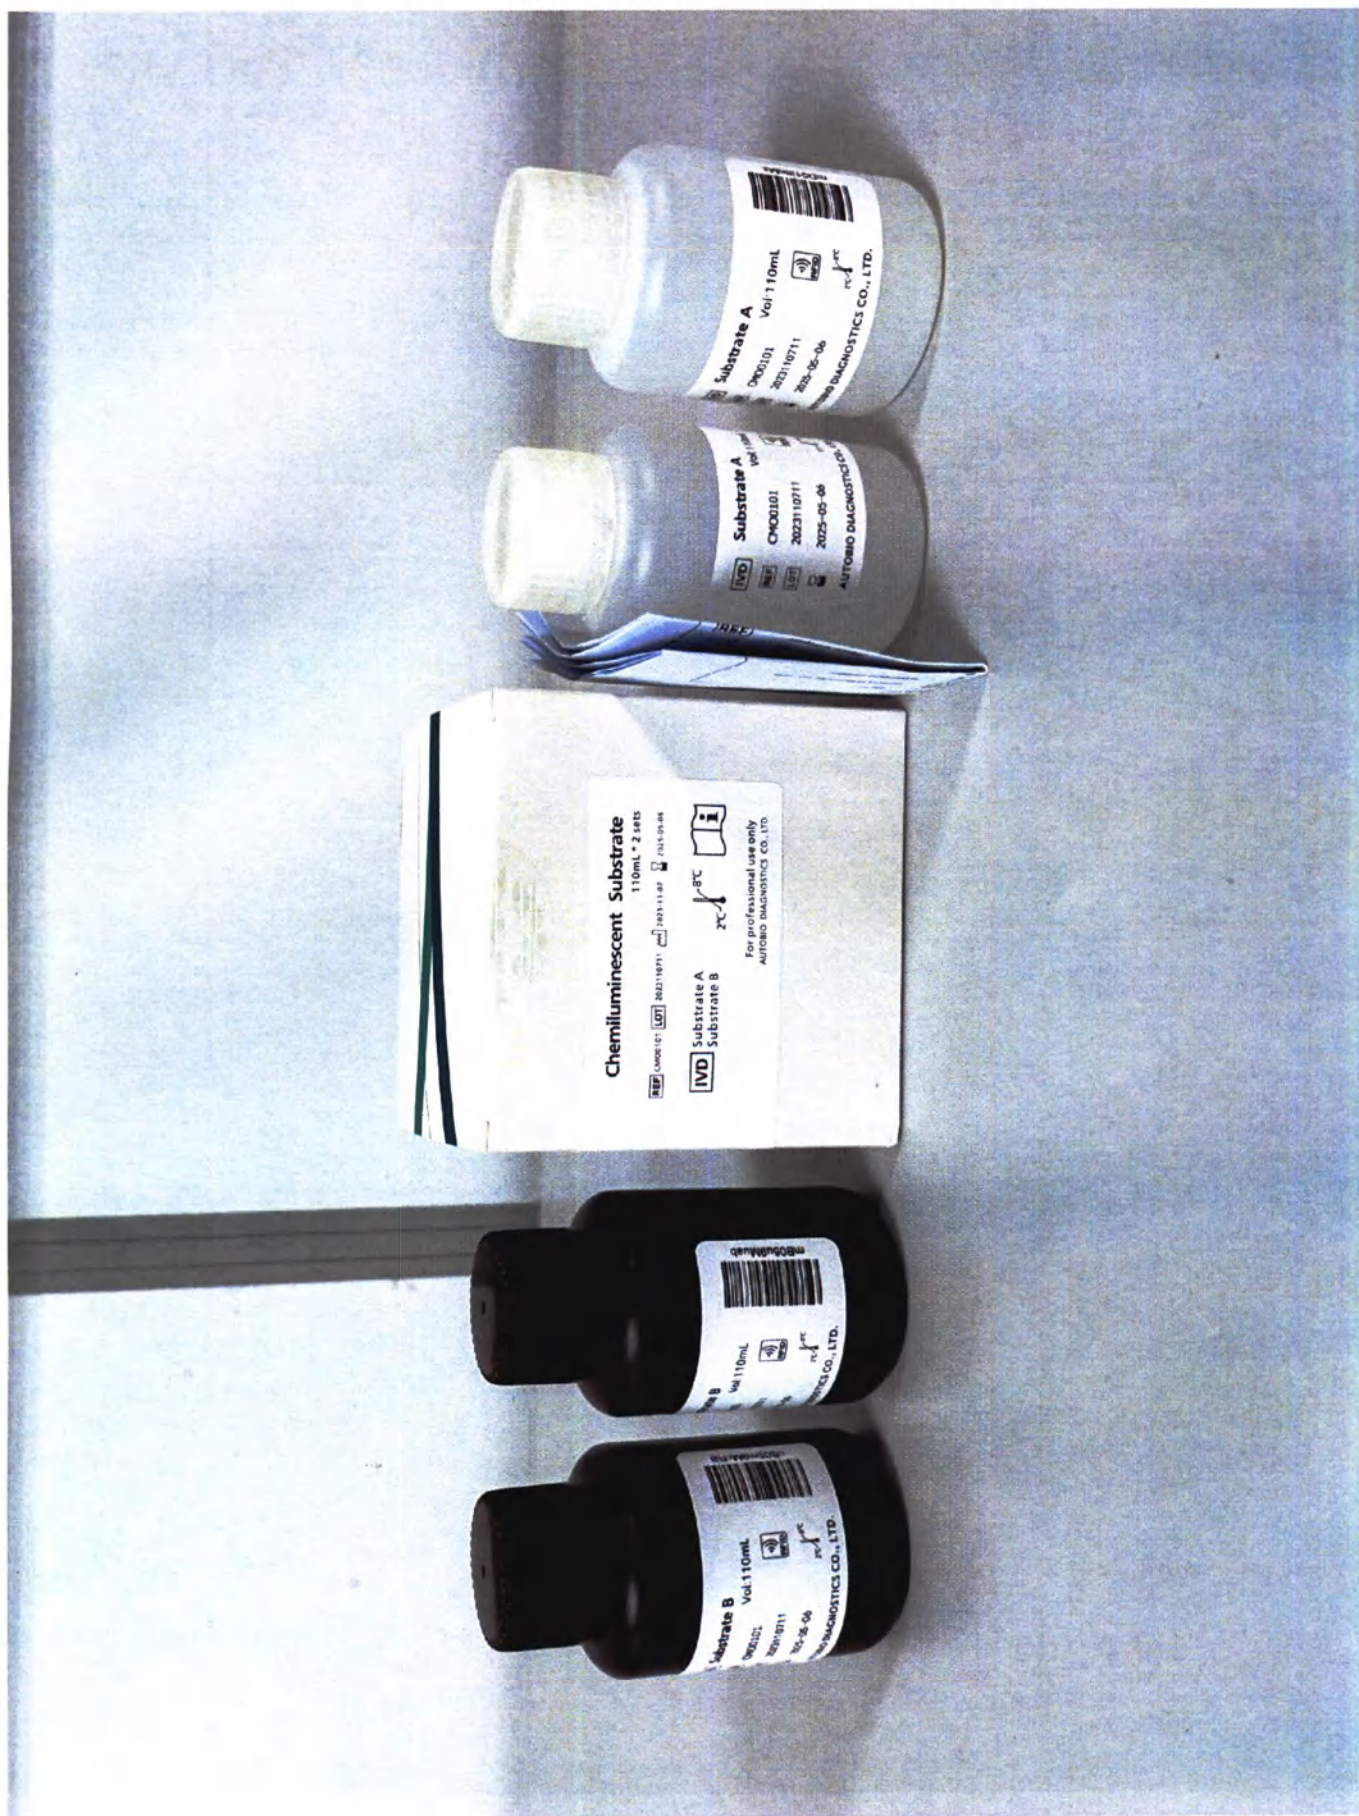


Фото субстрата А

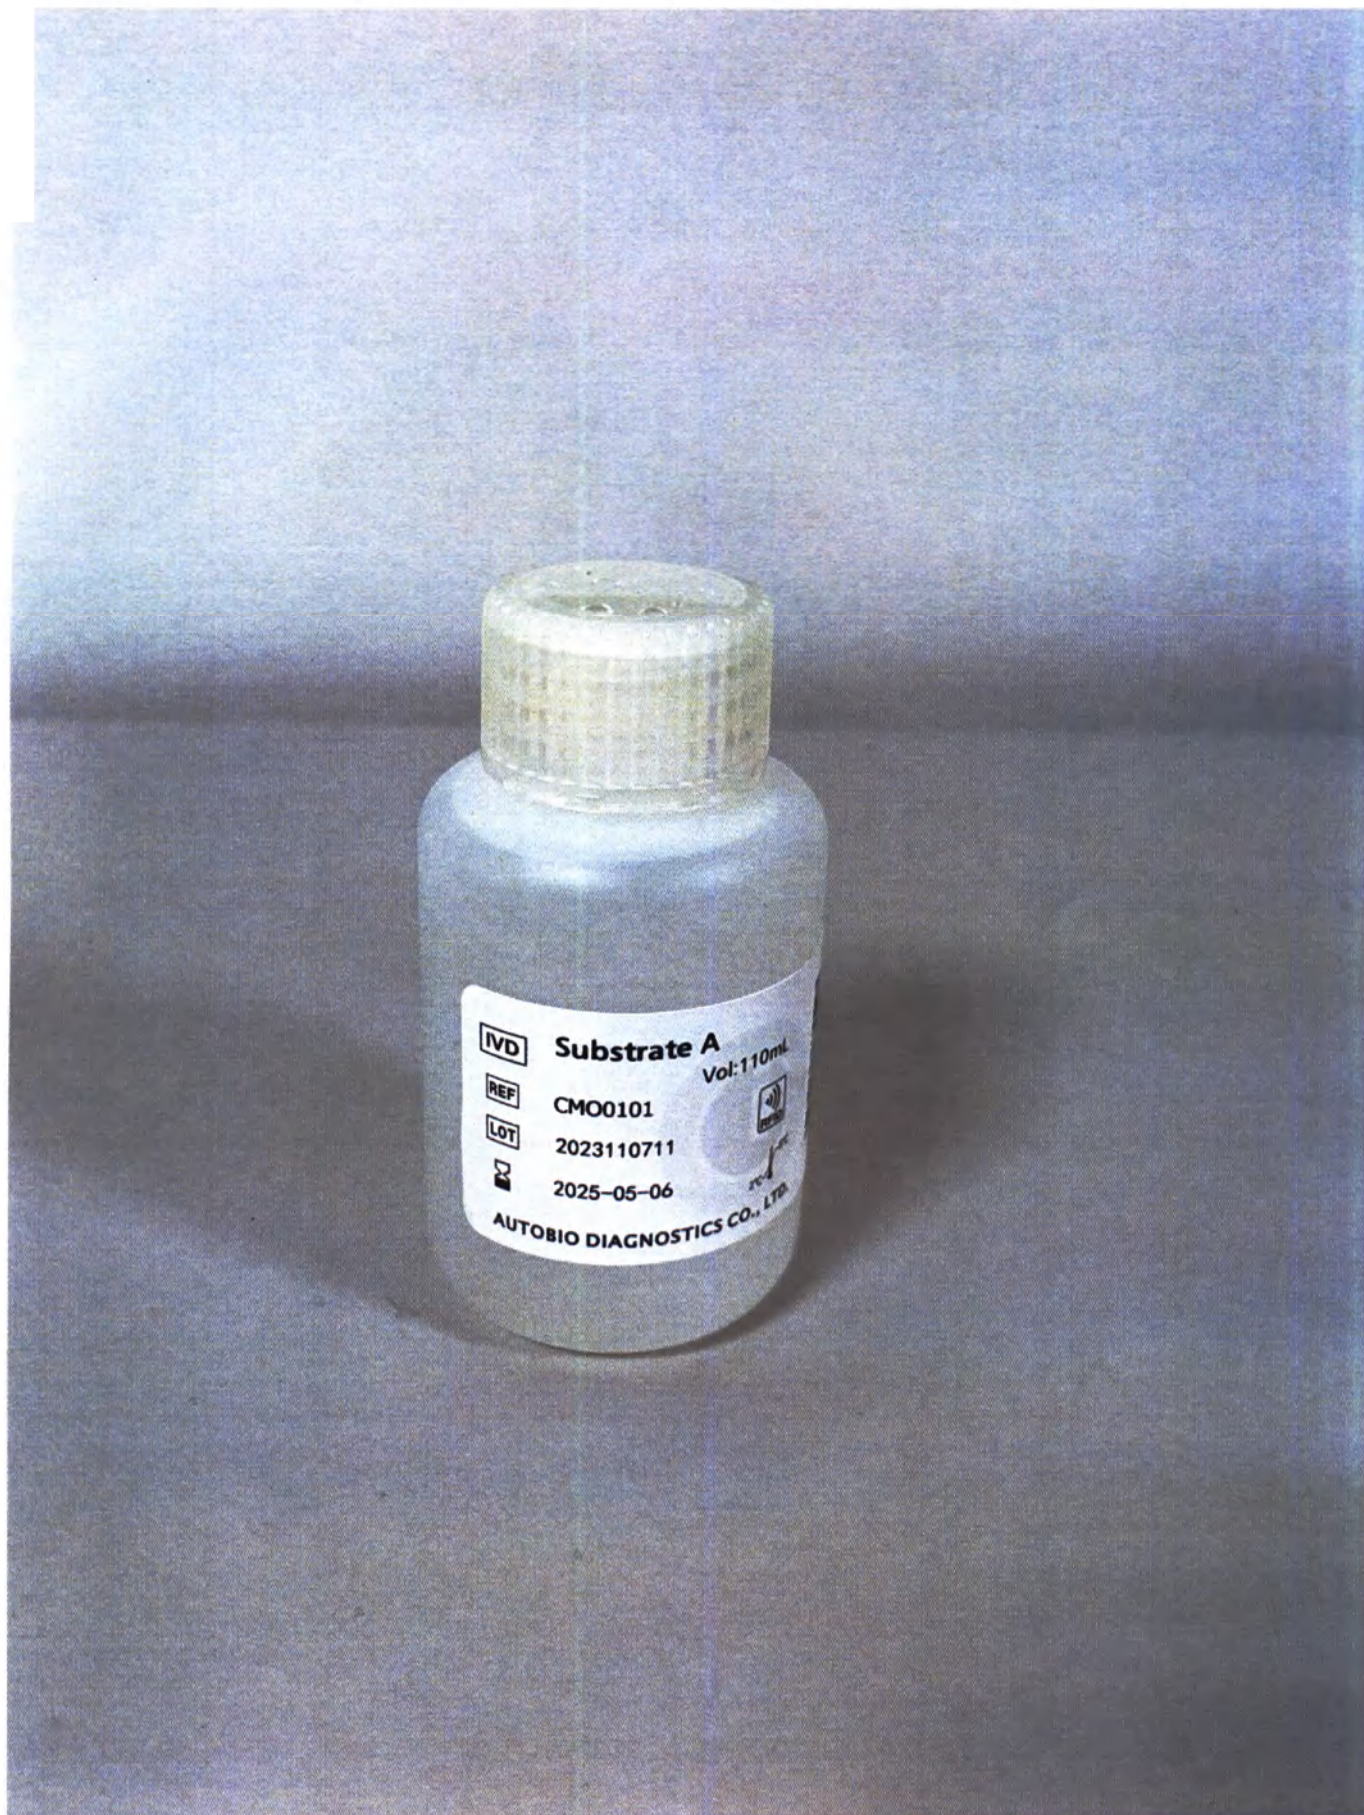




Фото субстрата В

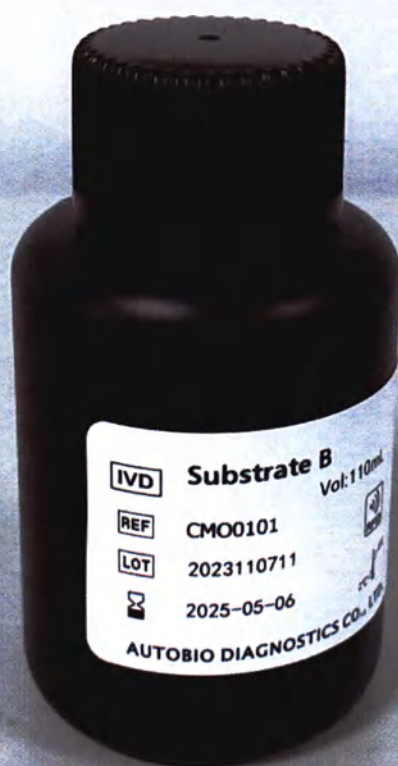




Фото транспортной упаковки медицинского изделия



Макеты русскоязычной маркировки

Набор хемилюминесцентных субстратов
(Chemiluminescent Substrate) для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Chemiluminescent Substrate

110mL * 2 sets

REF

CMO0101

LOT



IVD

Substrate A
Substrate B



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 10
(десяти) листах