

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109012, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Электрокардиограф, в вариантах исполнения

Электрокардиограф CM1200A

Электрокардиограф CM1200B

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»



Кизилова А.М.

Электрокардиограф CM1200A



Электрокардиограф CM1200A: транспортная/потребительская коробка



FRAGILE
DO NOT STEP ON
HANDLE WITH CARE

Электрокардиограф CM1200A: манипуляционные надписи и знаки на транспортной/потребительской коробке

MODEL: CM1200A

DATE: 2022.09.27

NUMBER: 91220926001

ORDER NO#: FG20220917



91220926001

Электрокардиограф CM1200A: идентификационная наклейка на транспортной/потребительской коробке

COMEN

Электрокардиограф CM1200A

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Размер упаковки: 530мм (длина)х 270мм (глубина) х430мм (высота)

Масса нетто: 5,1 кг Масса брутто: 6,0 кг Количество в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.


(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.


Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.
6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMIT



HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Электрокардиограф CM1200A: макет маркировки транспортной/потребительской коробки



Блок базовый CM1200A (в воздушных пакетах для предотвращения повреждений)



Блок базовый CM1200A (вид сверху, передняя панель)



Блок базовый CM1200A (вид спереди)



Блок базовый CM1200A (вид сбоку)



Блок базовый CM1200A (вид сбоку, разъемы)



Блок базовый CM1200A (вид сбоку, разъемы)



Блок базовый CM1200A (вид сбоку)



Блок базовый CM1200A (вид сбоку с открытым принтером)



Блок базовый CM1200A (вид сзади)



Блок базовый CM1200A (вид сзади, разъемы)



Блок базовый CM1200A (вид снизу, задняя панель)

SN 91220926003



26.09.2022

COMEN




Электрокардиограф CM1200A

Номинальное напряжение: 100-240В~

Номинальная частота: 50/60Гц

Номинальная мощность: 95ВА



IPX0

Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)


Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5
of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,
Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:


ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть
помещ. 6Н С НОМ 39.49

Блок базовый CM1200A (маркировка)

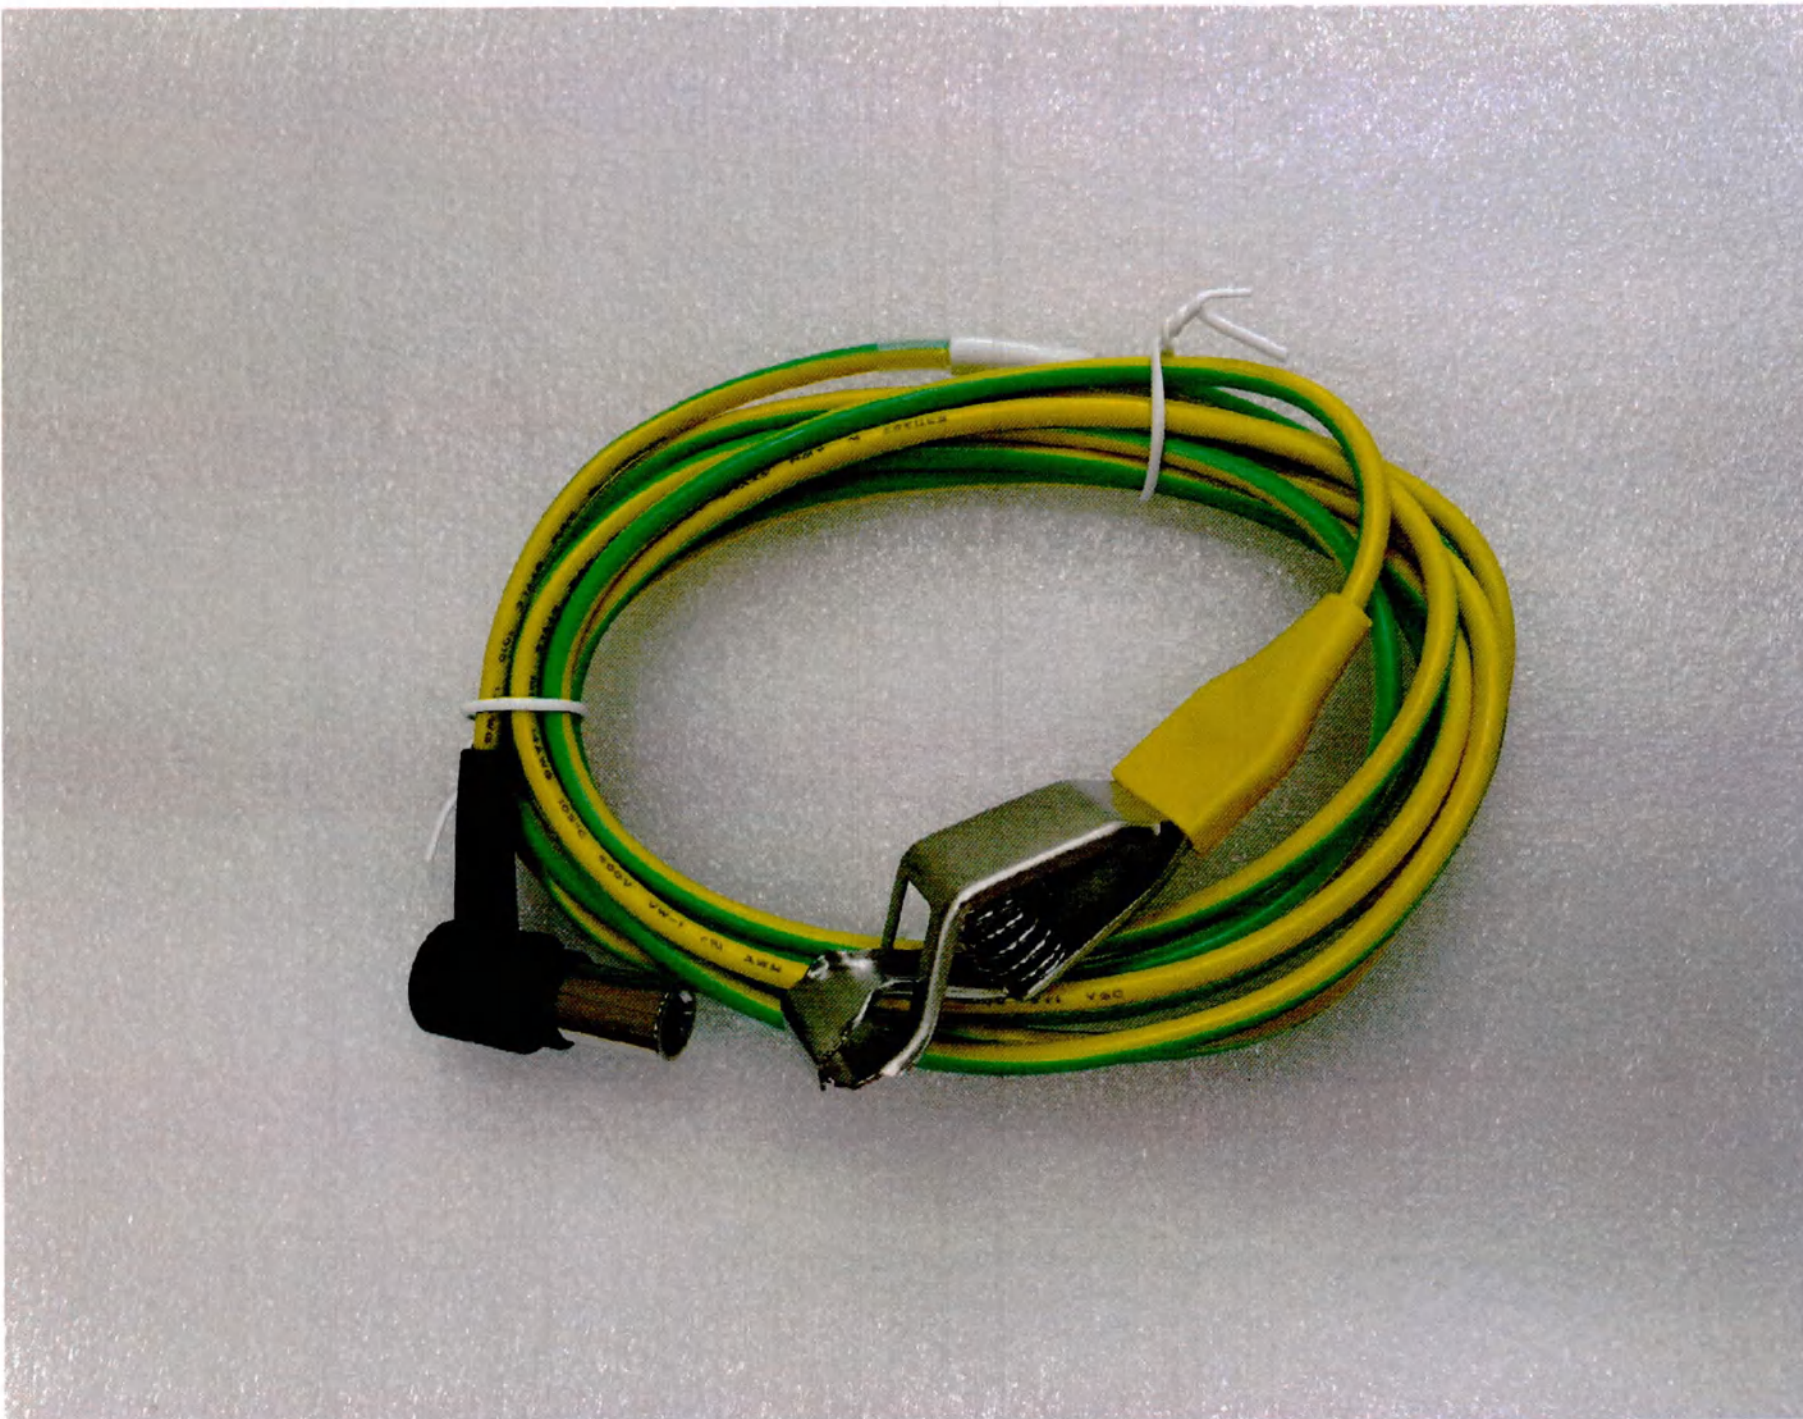

Кабель заземления

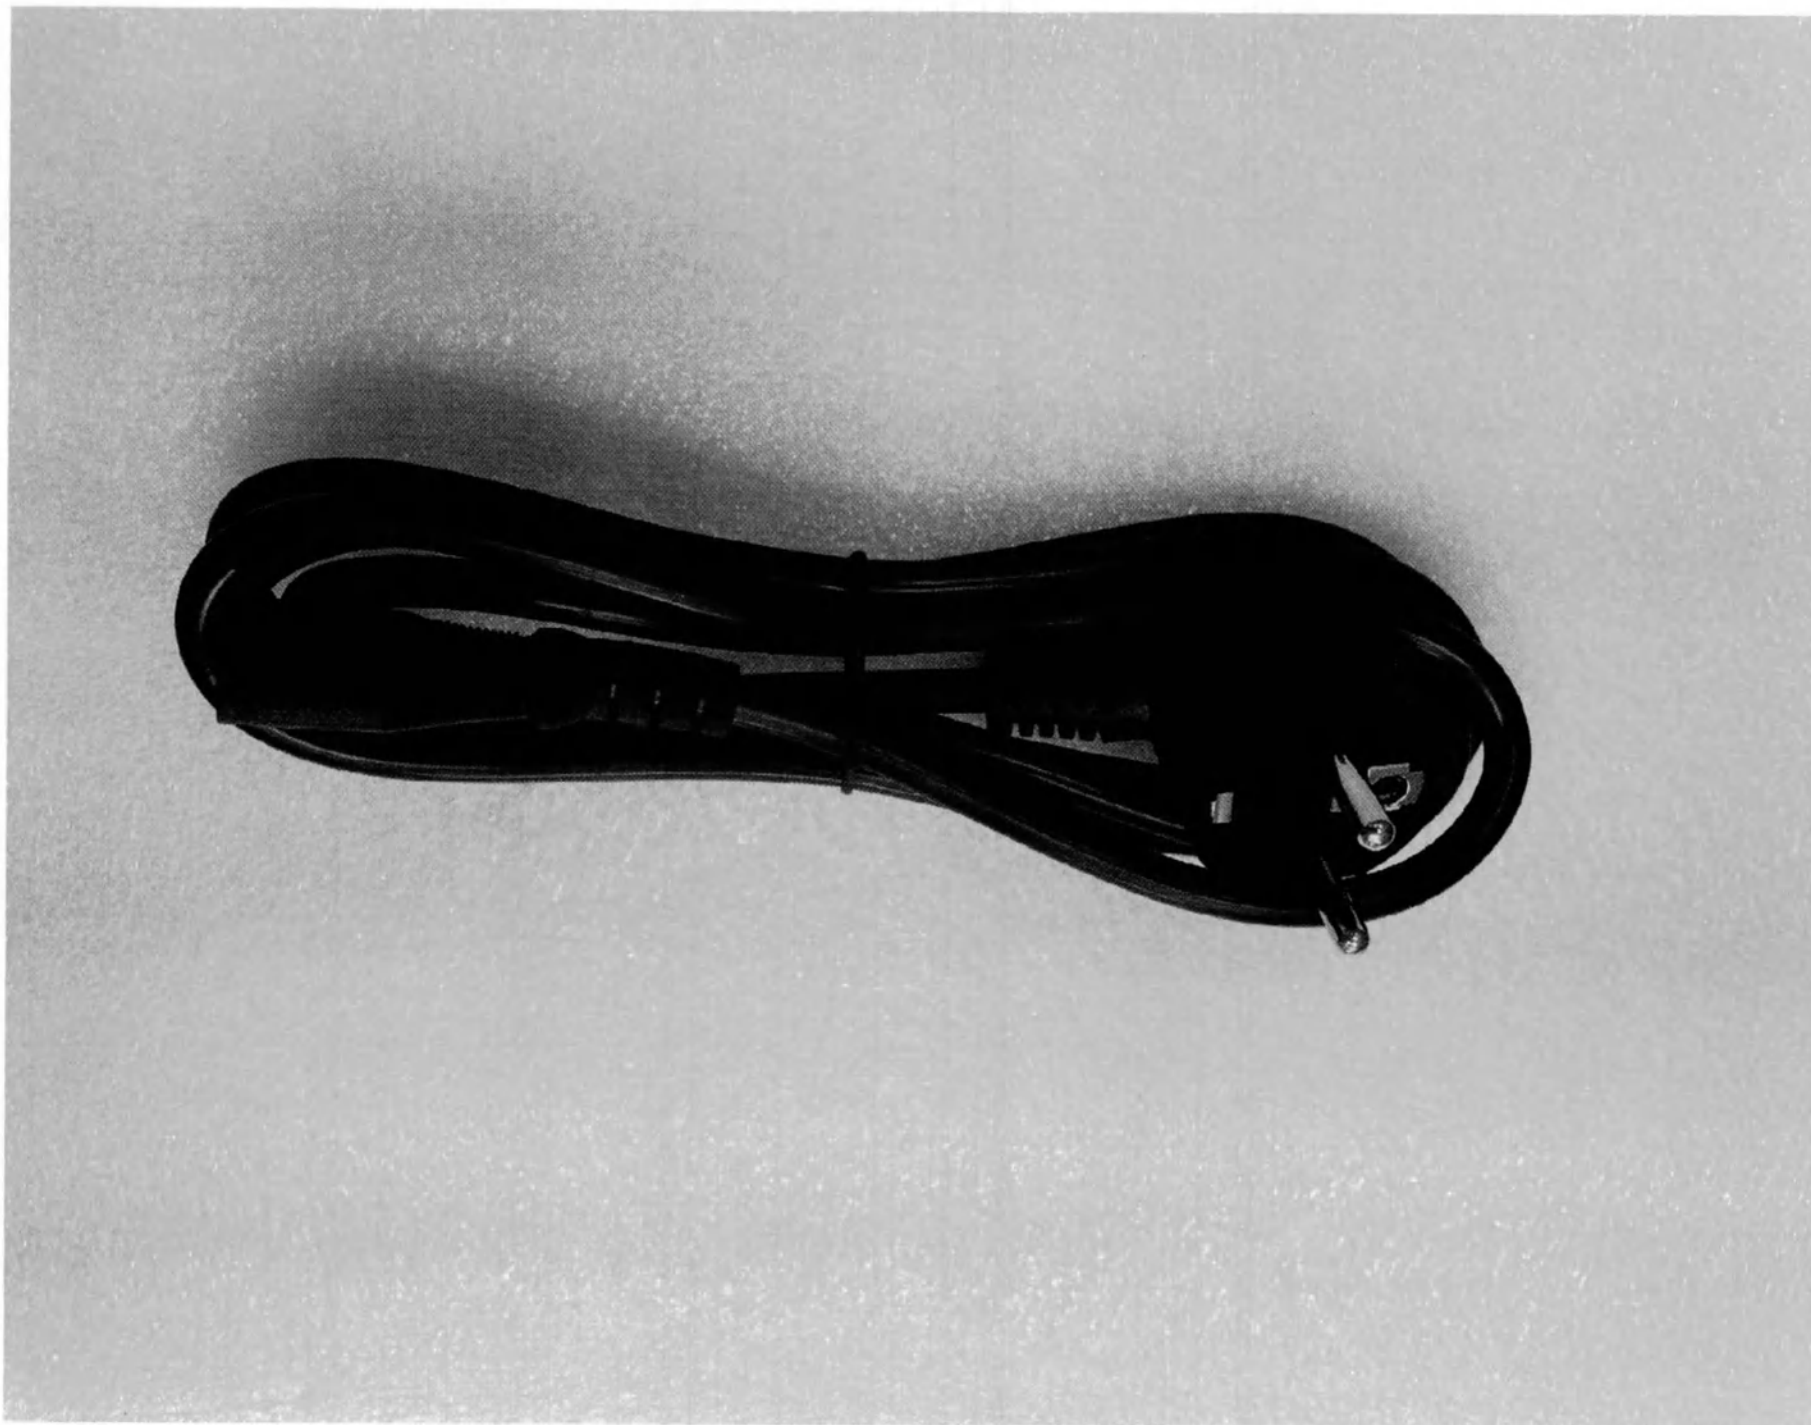

Кабель питания

Revision 1 / Редакция 1

	«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ» Director General / Генеральный директор Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./ Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд. _____ Yi Yong (И Юн) « 02 » _____ 2023 г. Stamp/печать
--	--

USER MANUAL OF MEDICAL DEVICE/
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Electrocardiograph, in versions/
 Электрокардиограф, в вариантах исполнения**


**Electrocardiograph CM1200A/
 Электрокардиограф CM1200A**

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./
 Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.




Кабель ЭКГ на 12 отведений: Пример индивидуальной упаковки

SN**20230303 0031****03.03.2023****COMEN****Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1****Количество в упаковке – 1 шт.****Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.****(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)****Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China****Уполномоченный представитель на территории РФ:****ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.****Регистрационное удостоверение №**

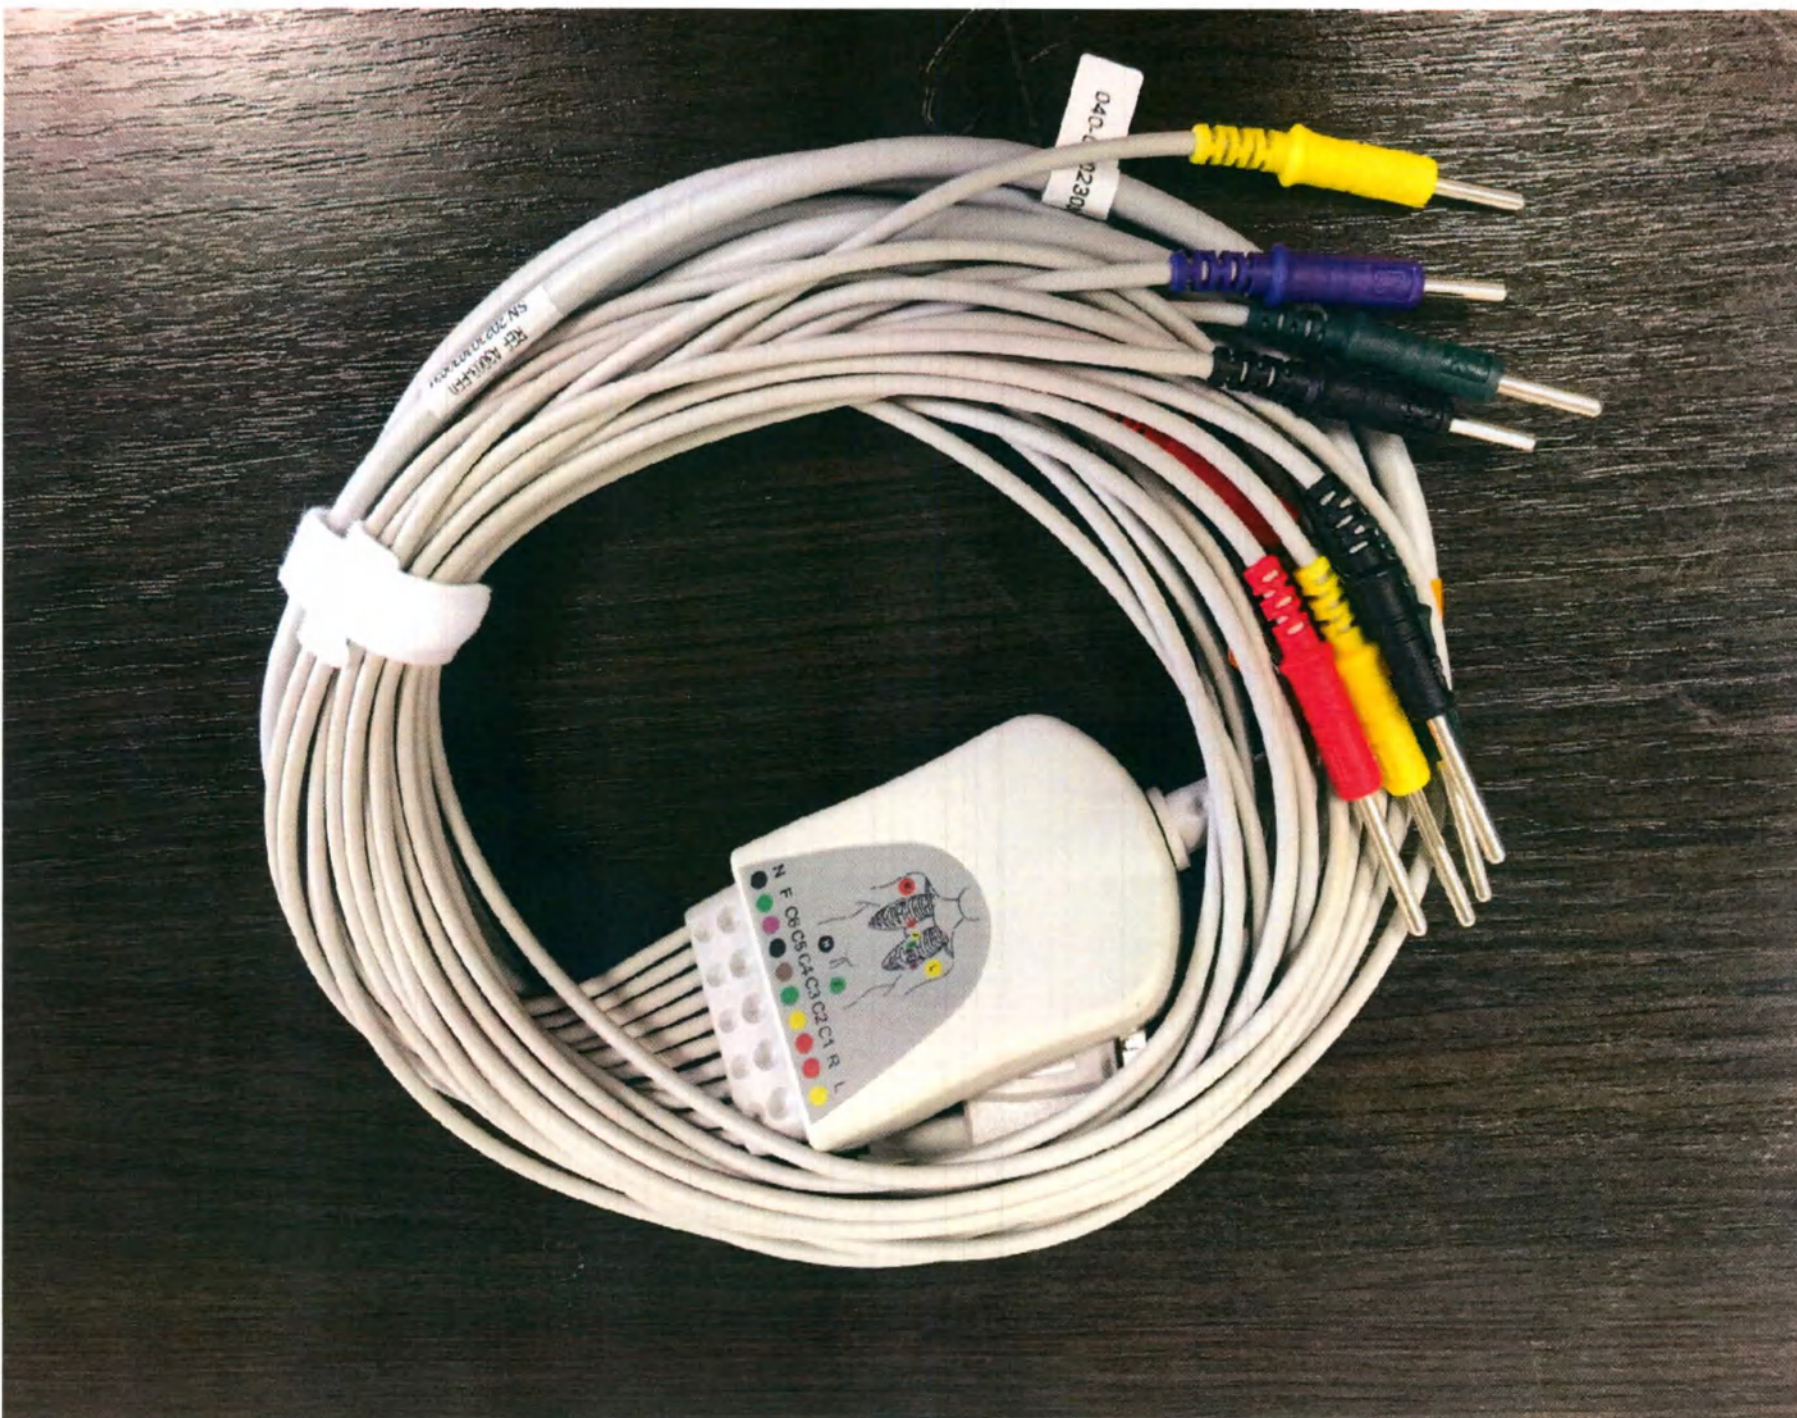


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (общий вид)

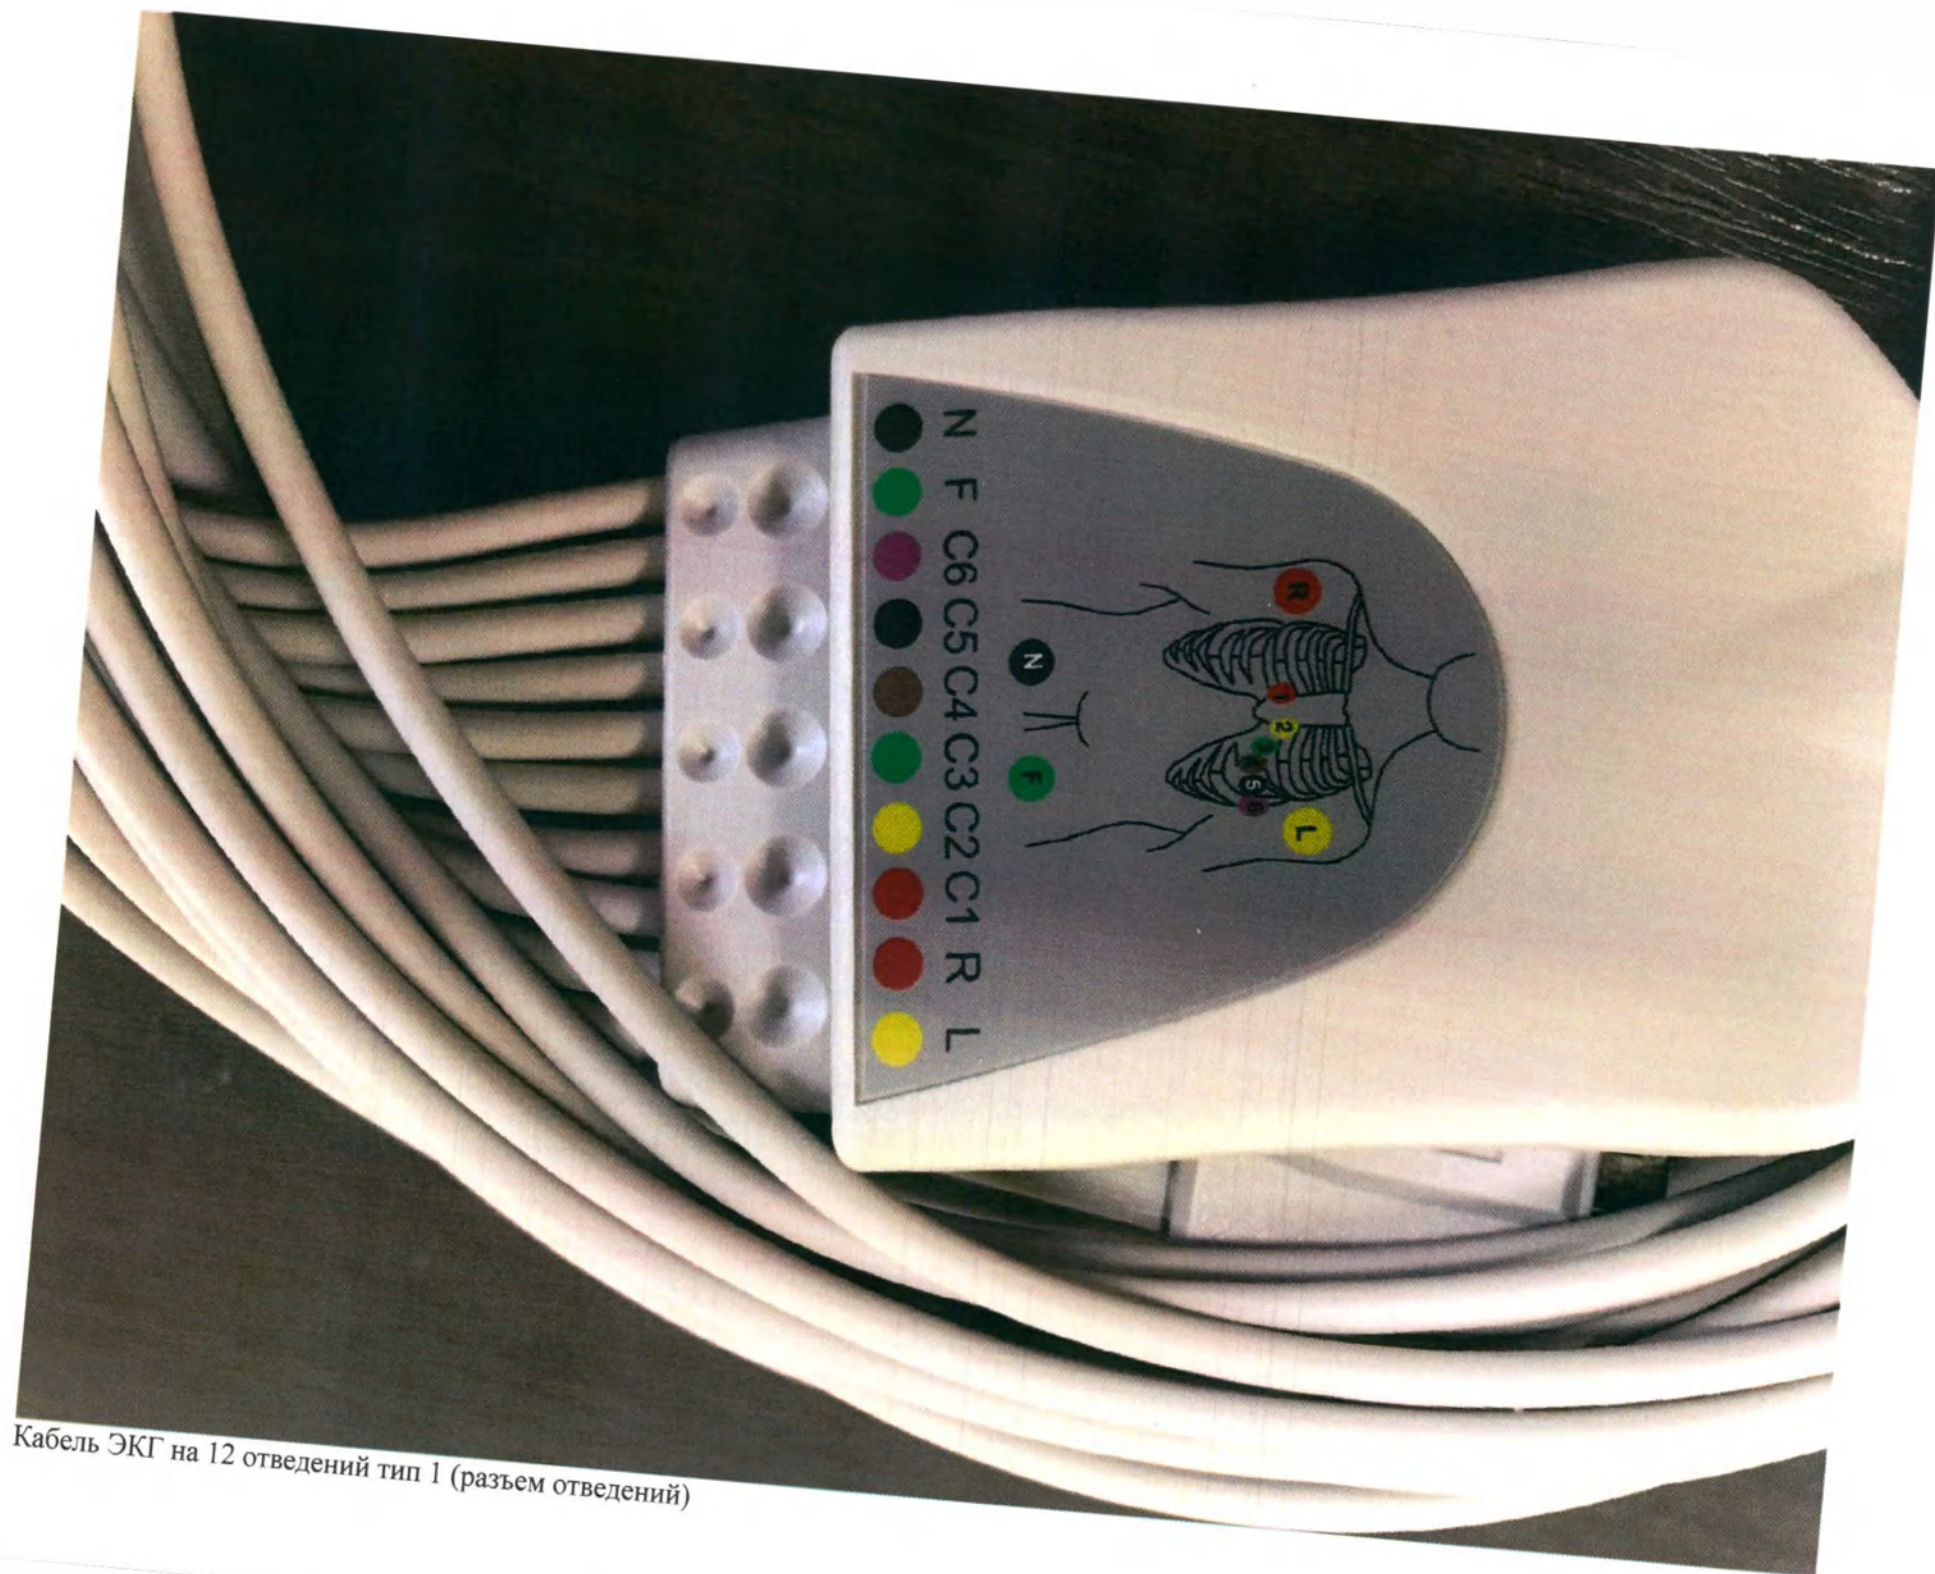


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (разъем отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (маркировка разъема отведений)

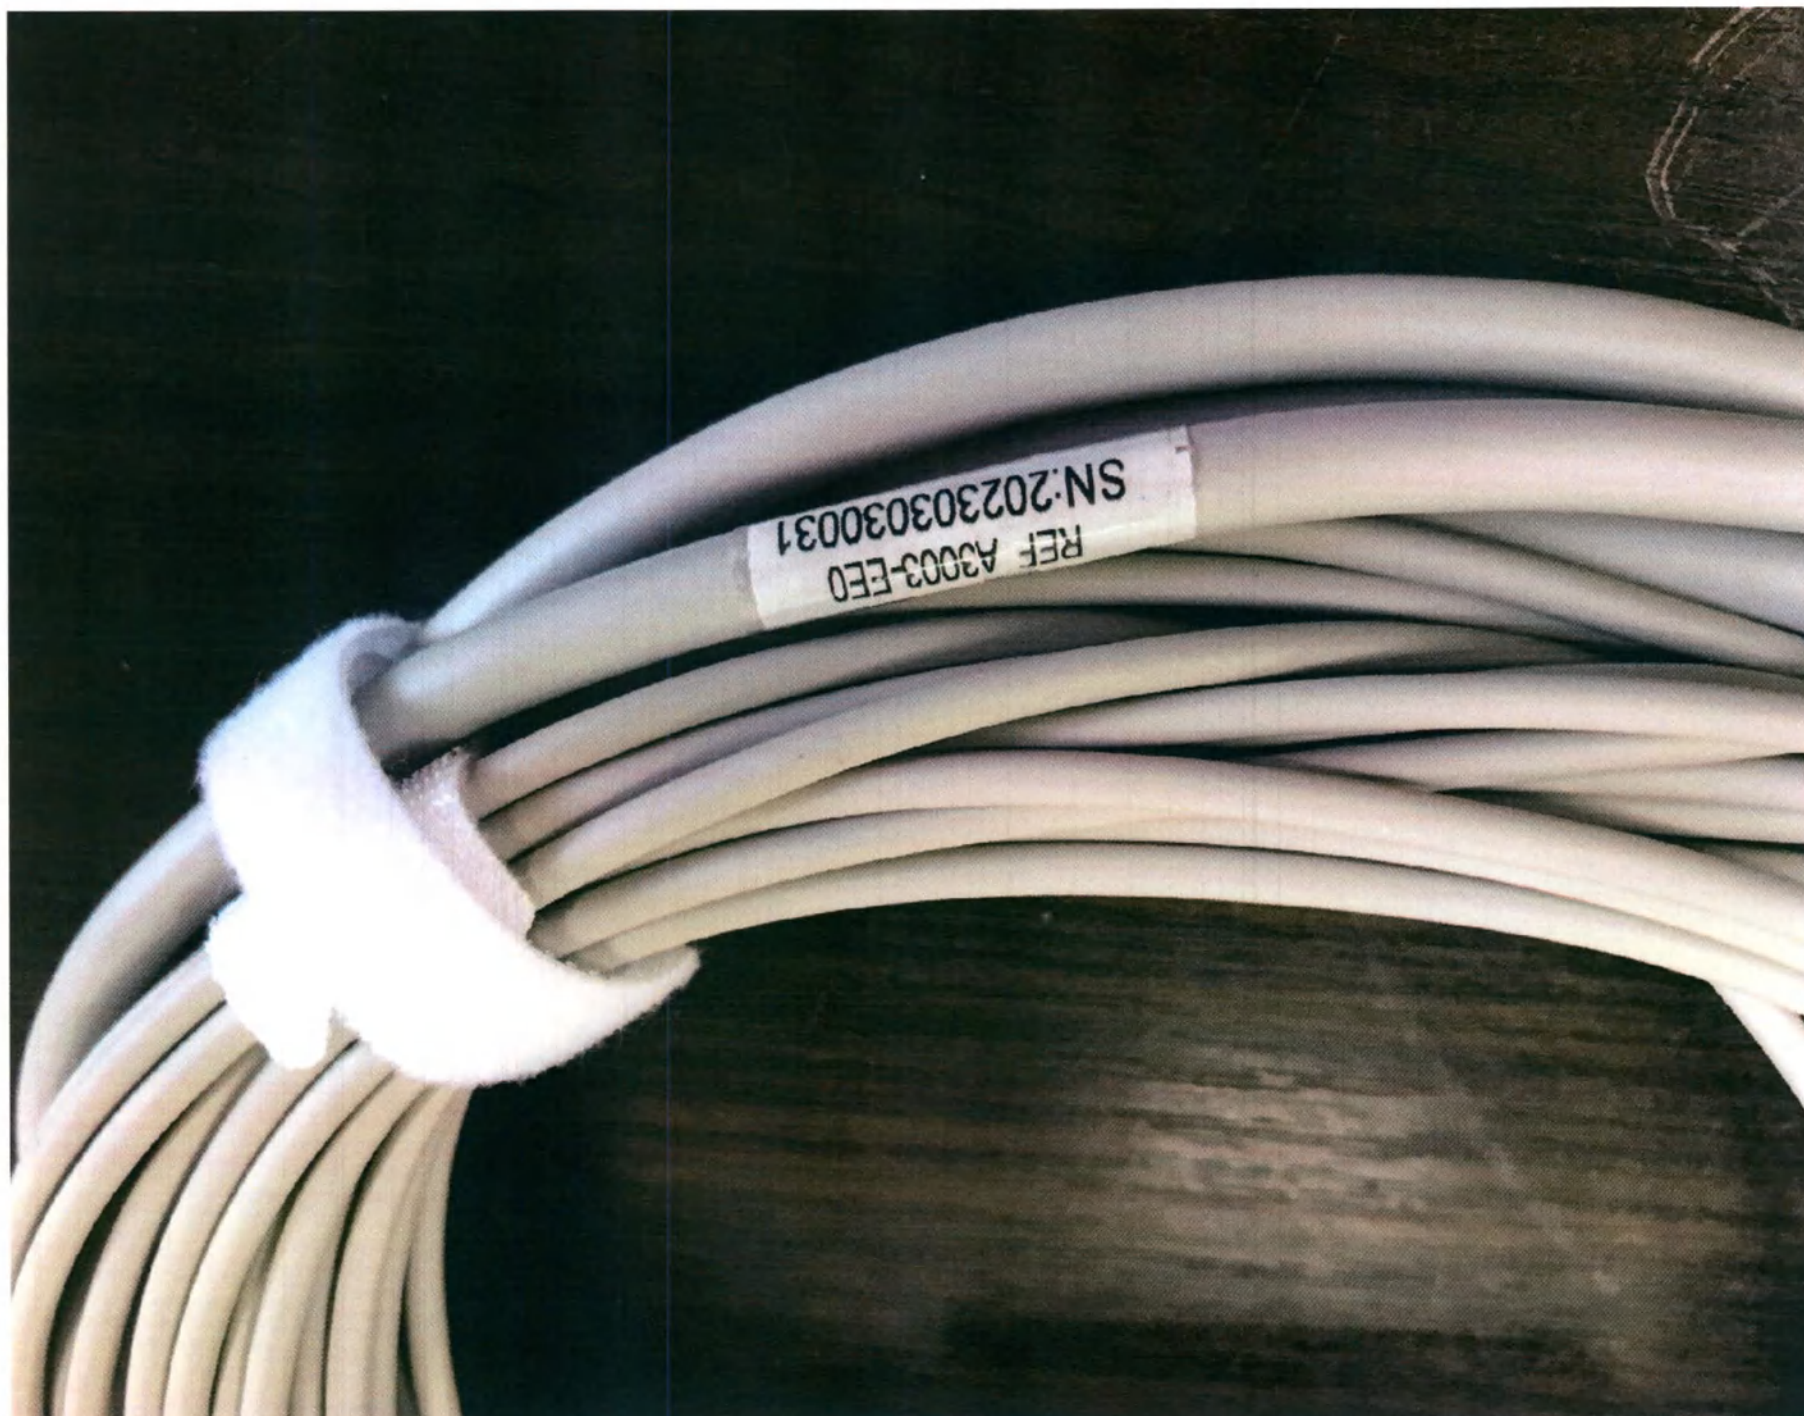

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (наклейка с серийным номером)

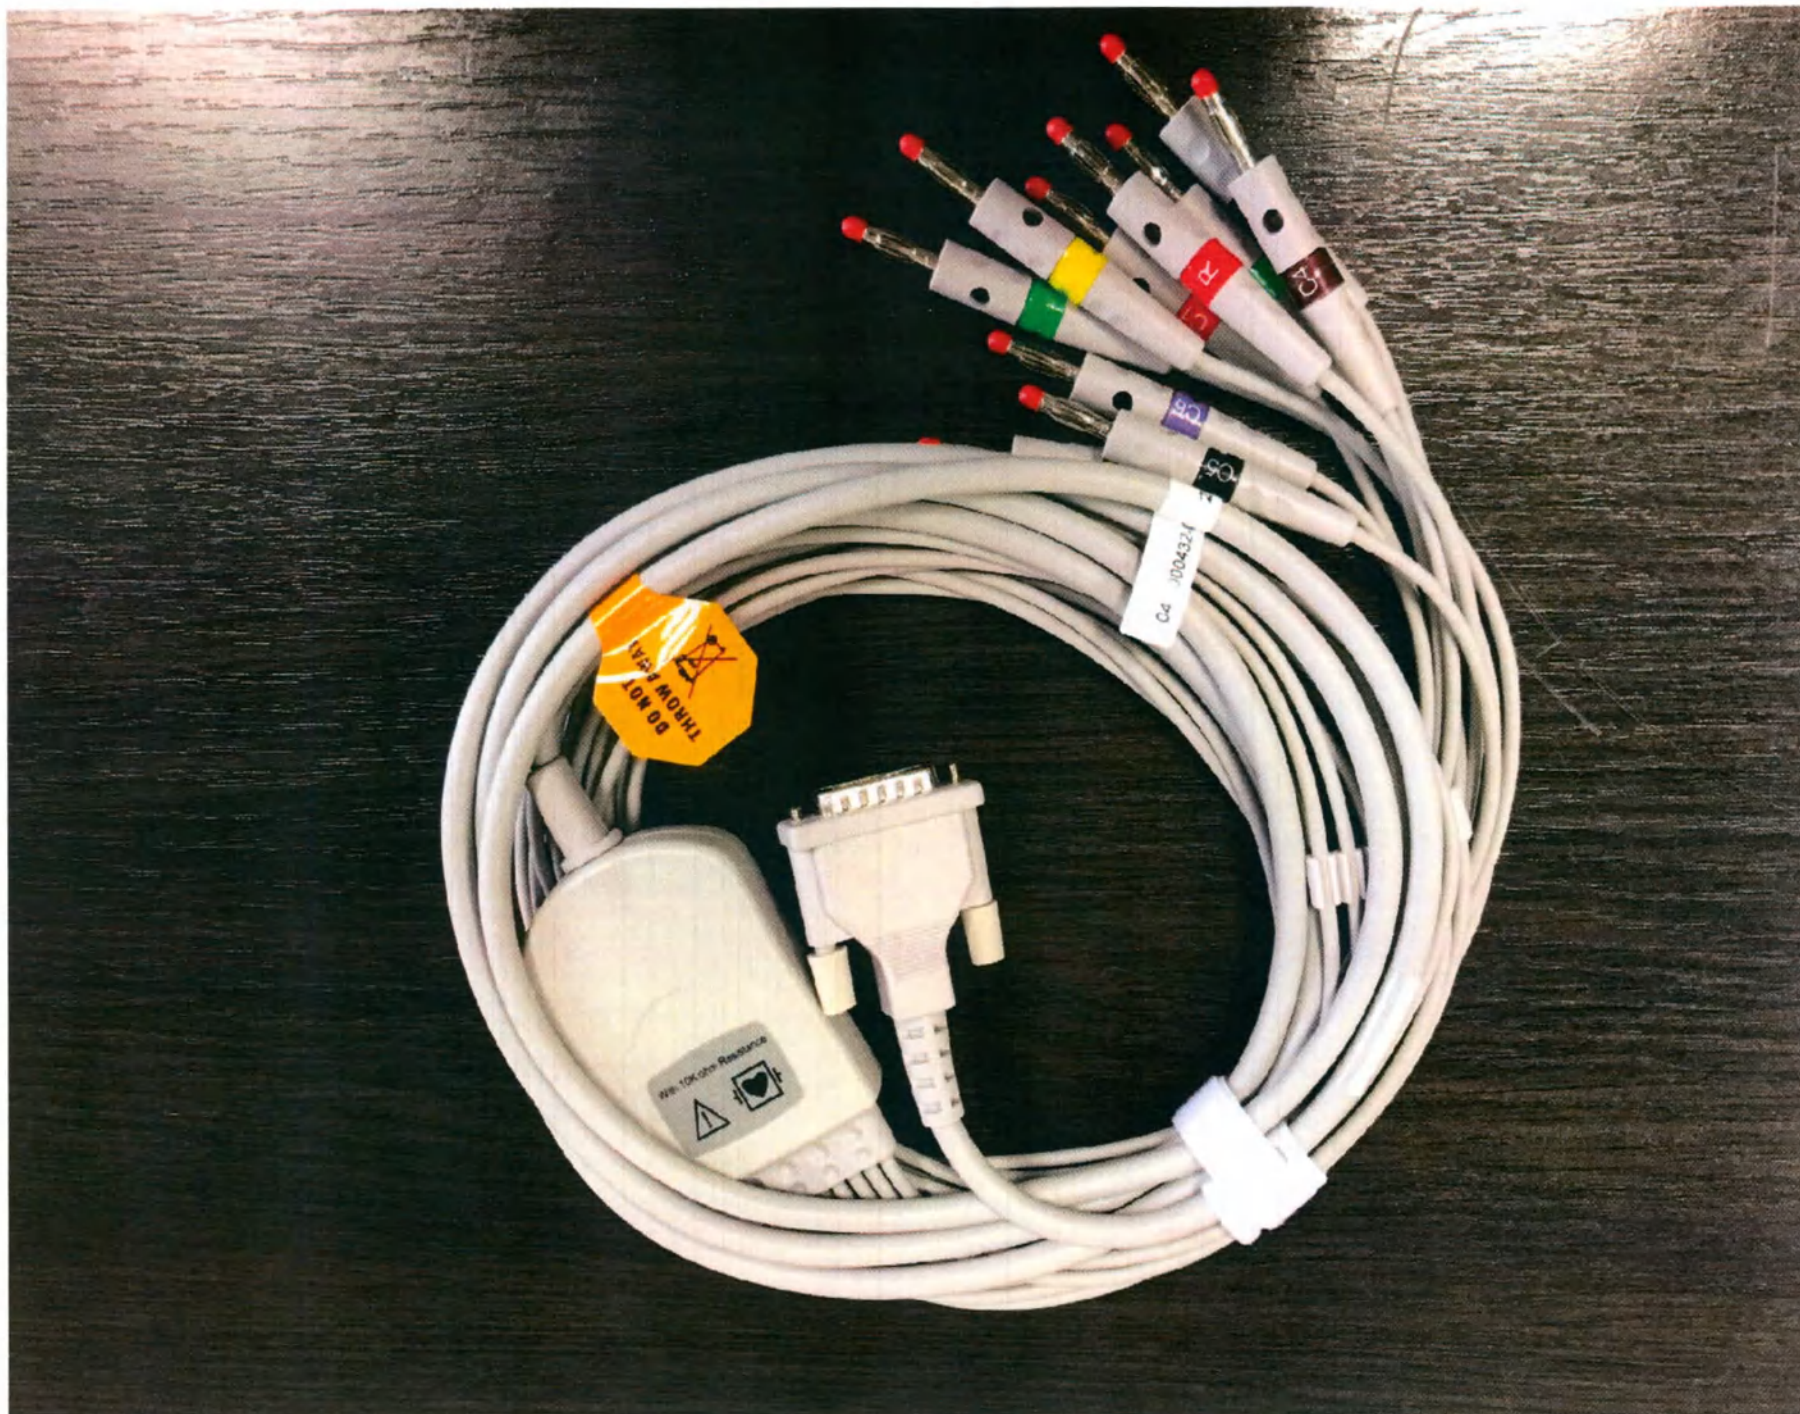

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (общий вид)

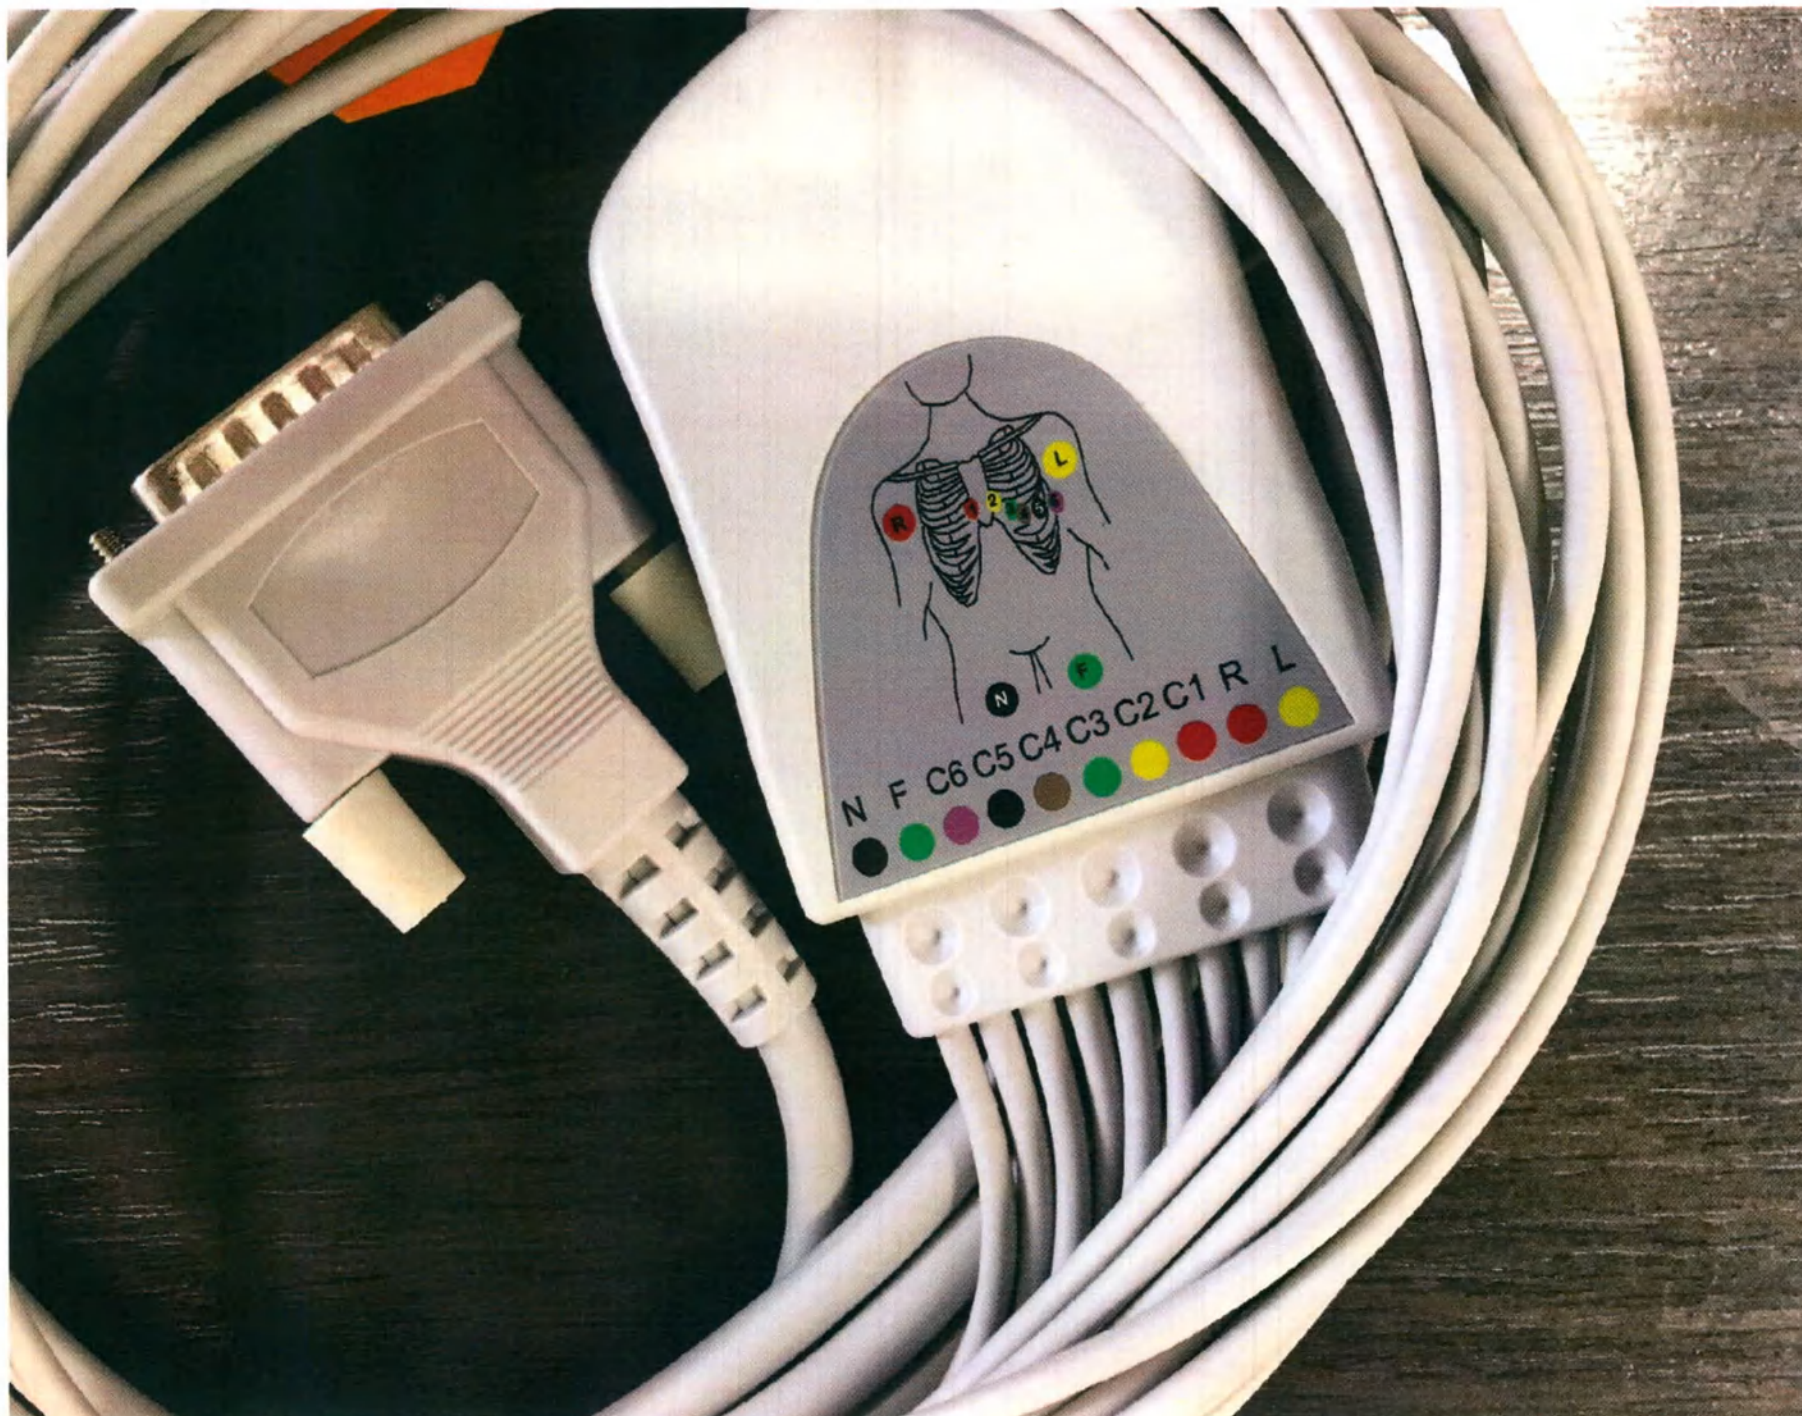


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений, маркировка)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (наклейка с серийным номером)

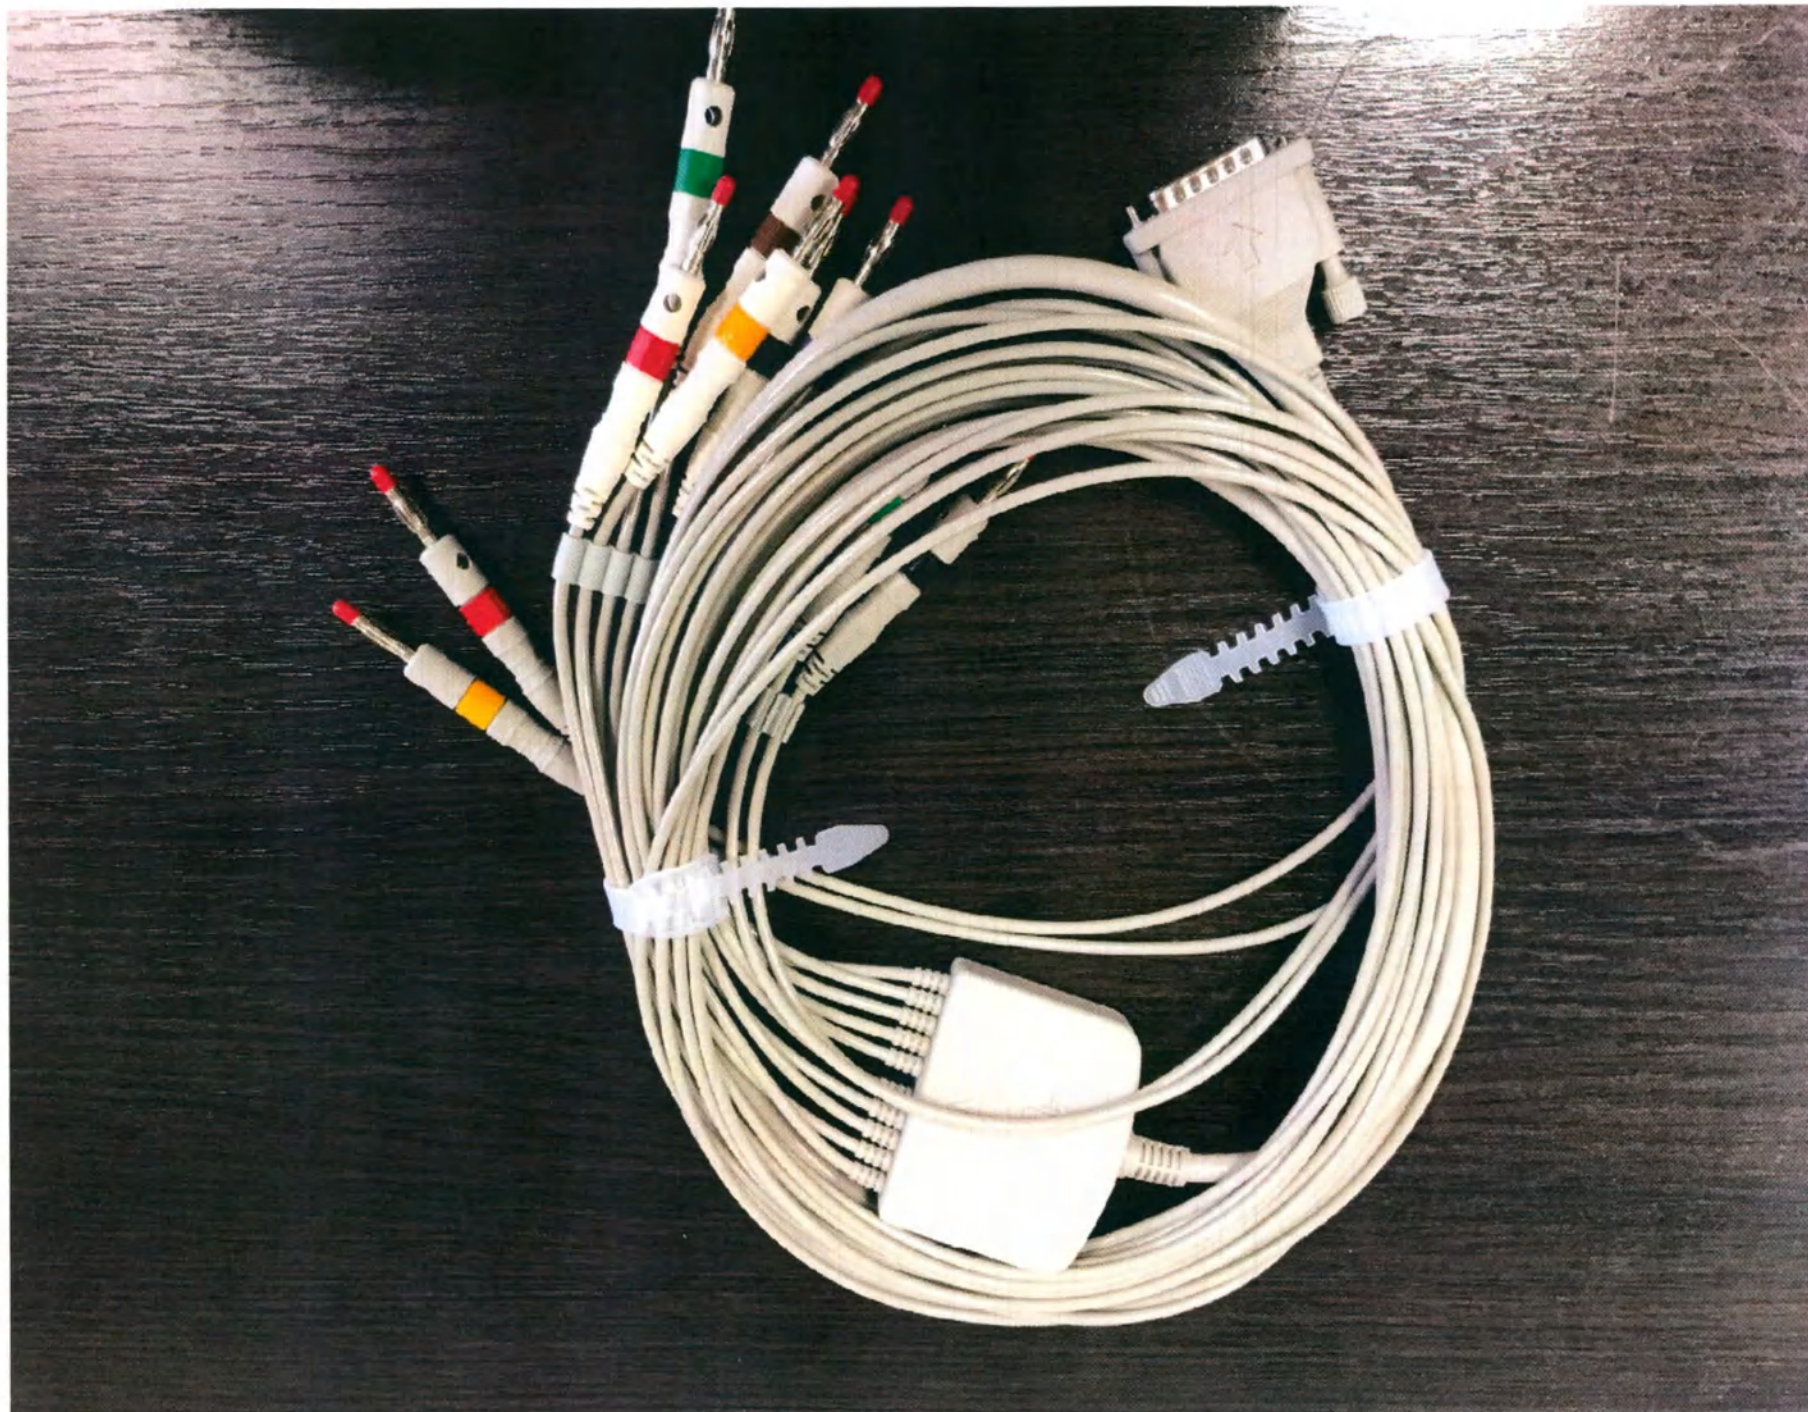

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (общий вид))

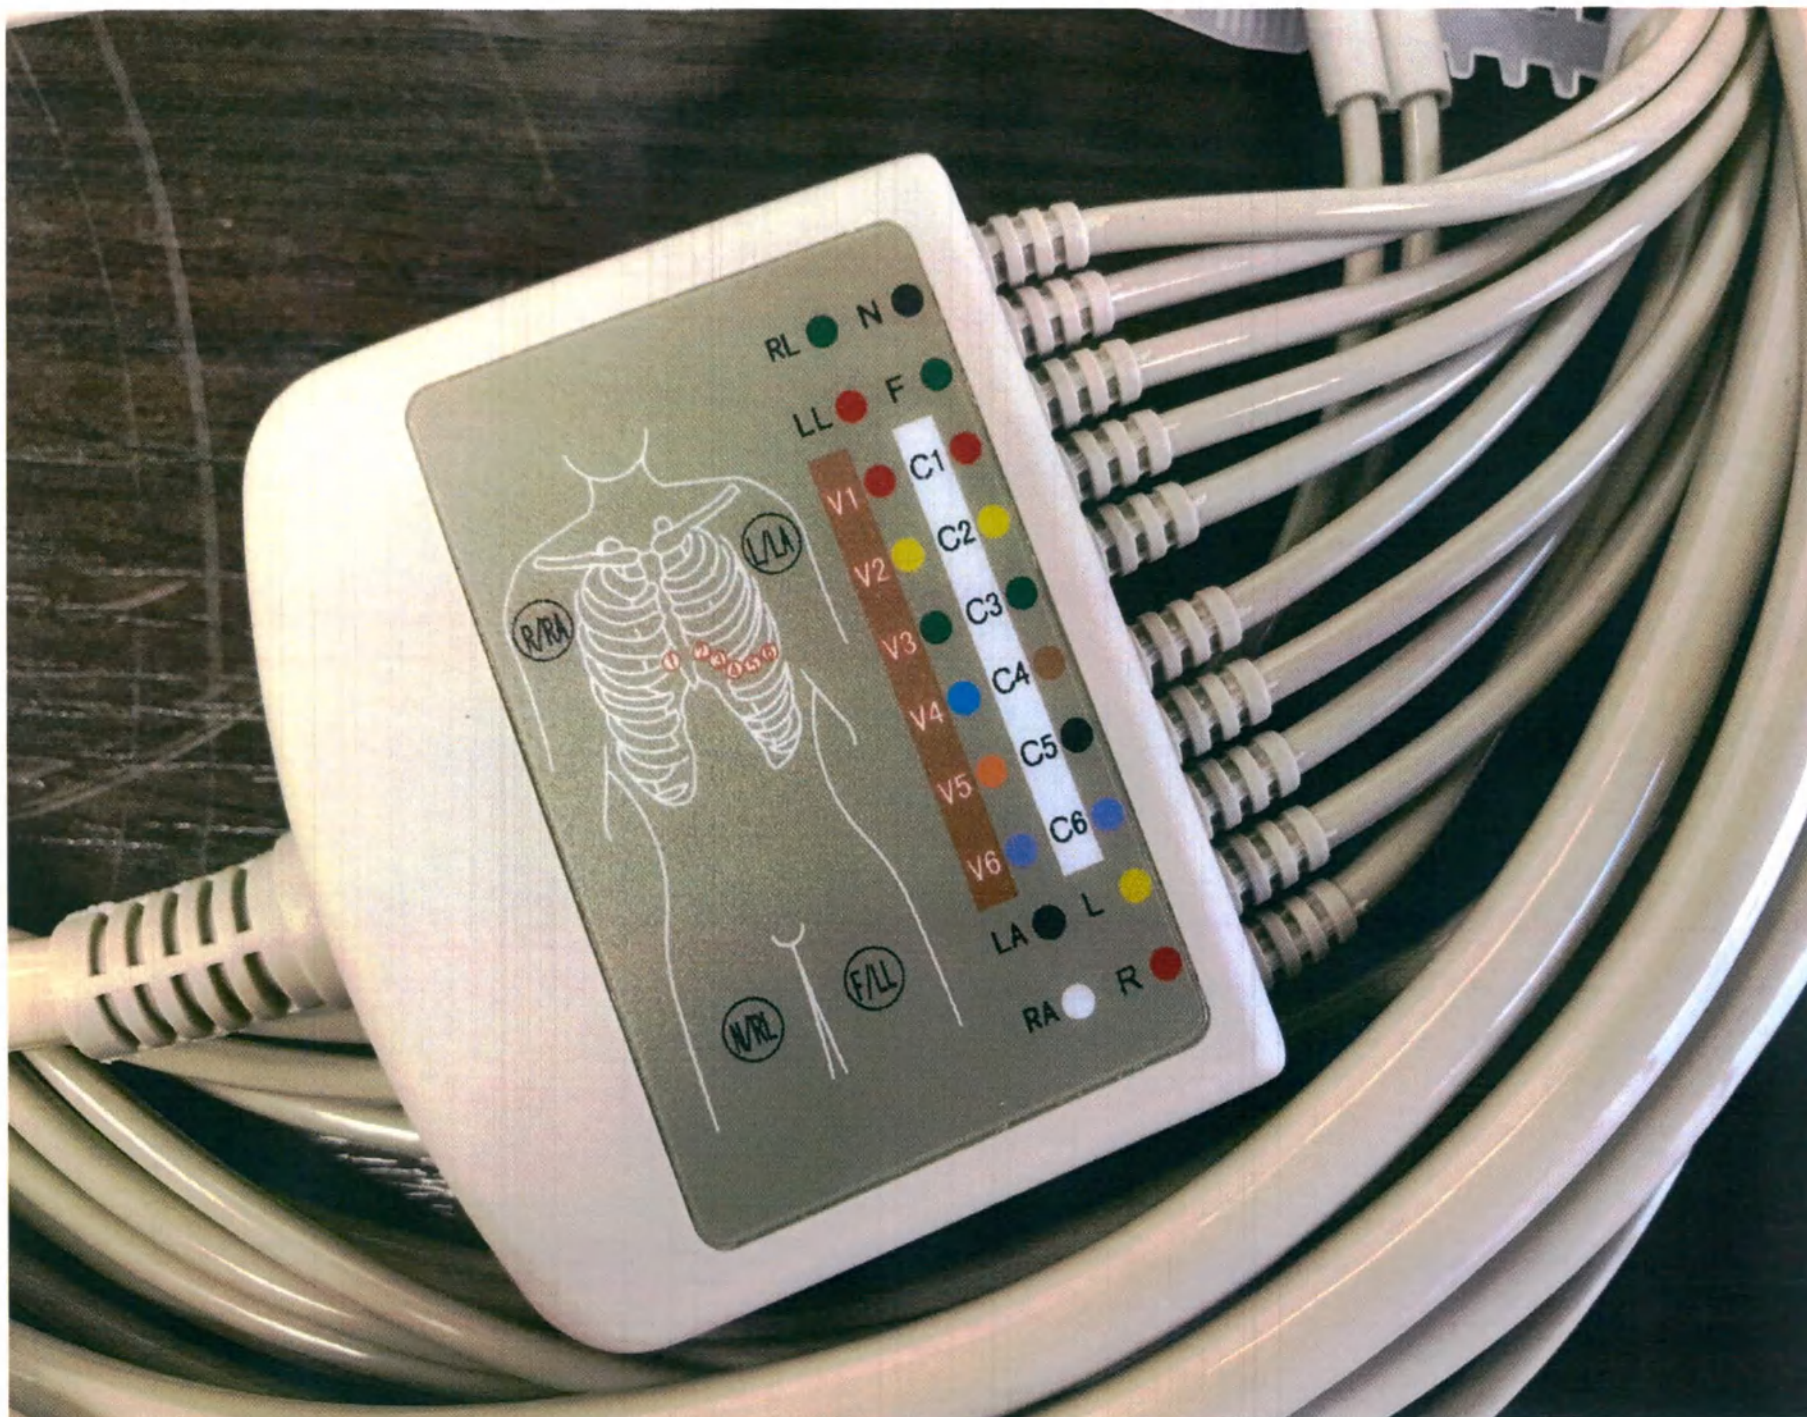


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (разъем отведений)

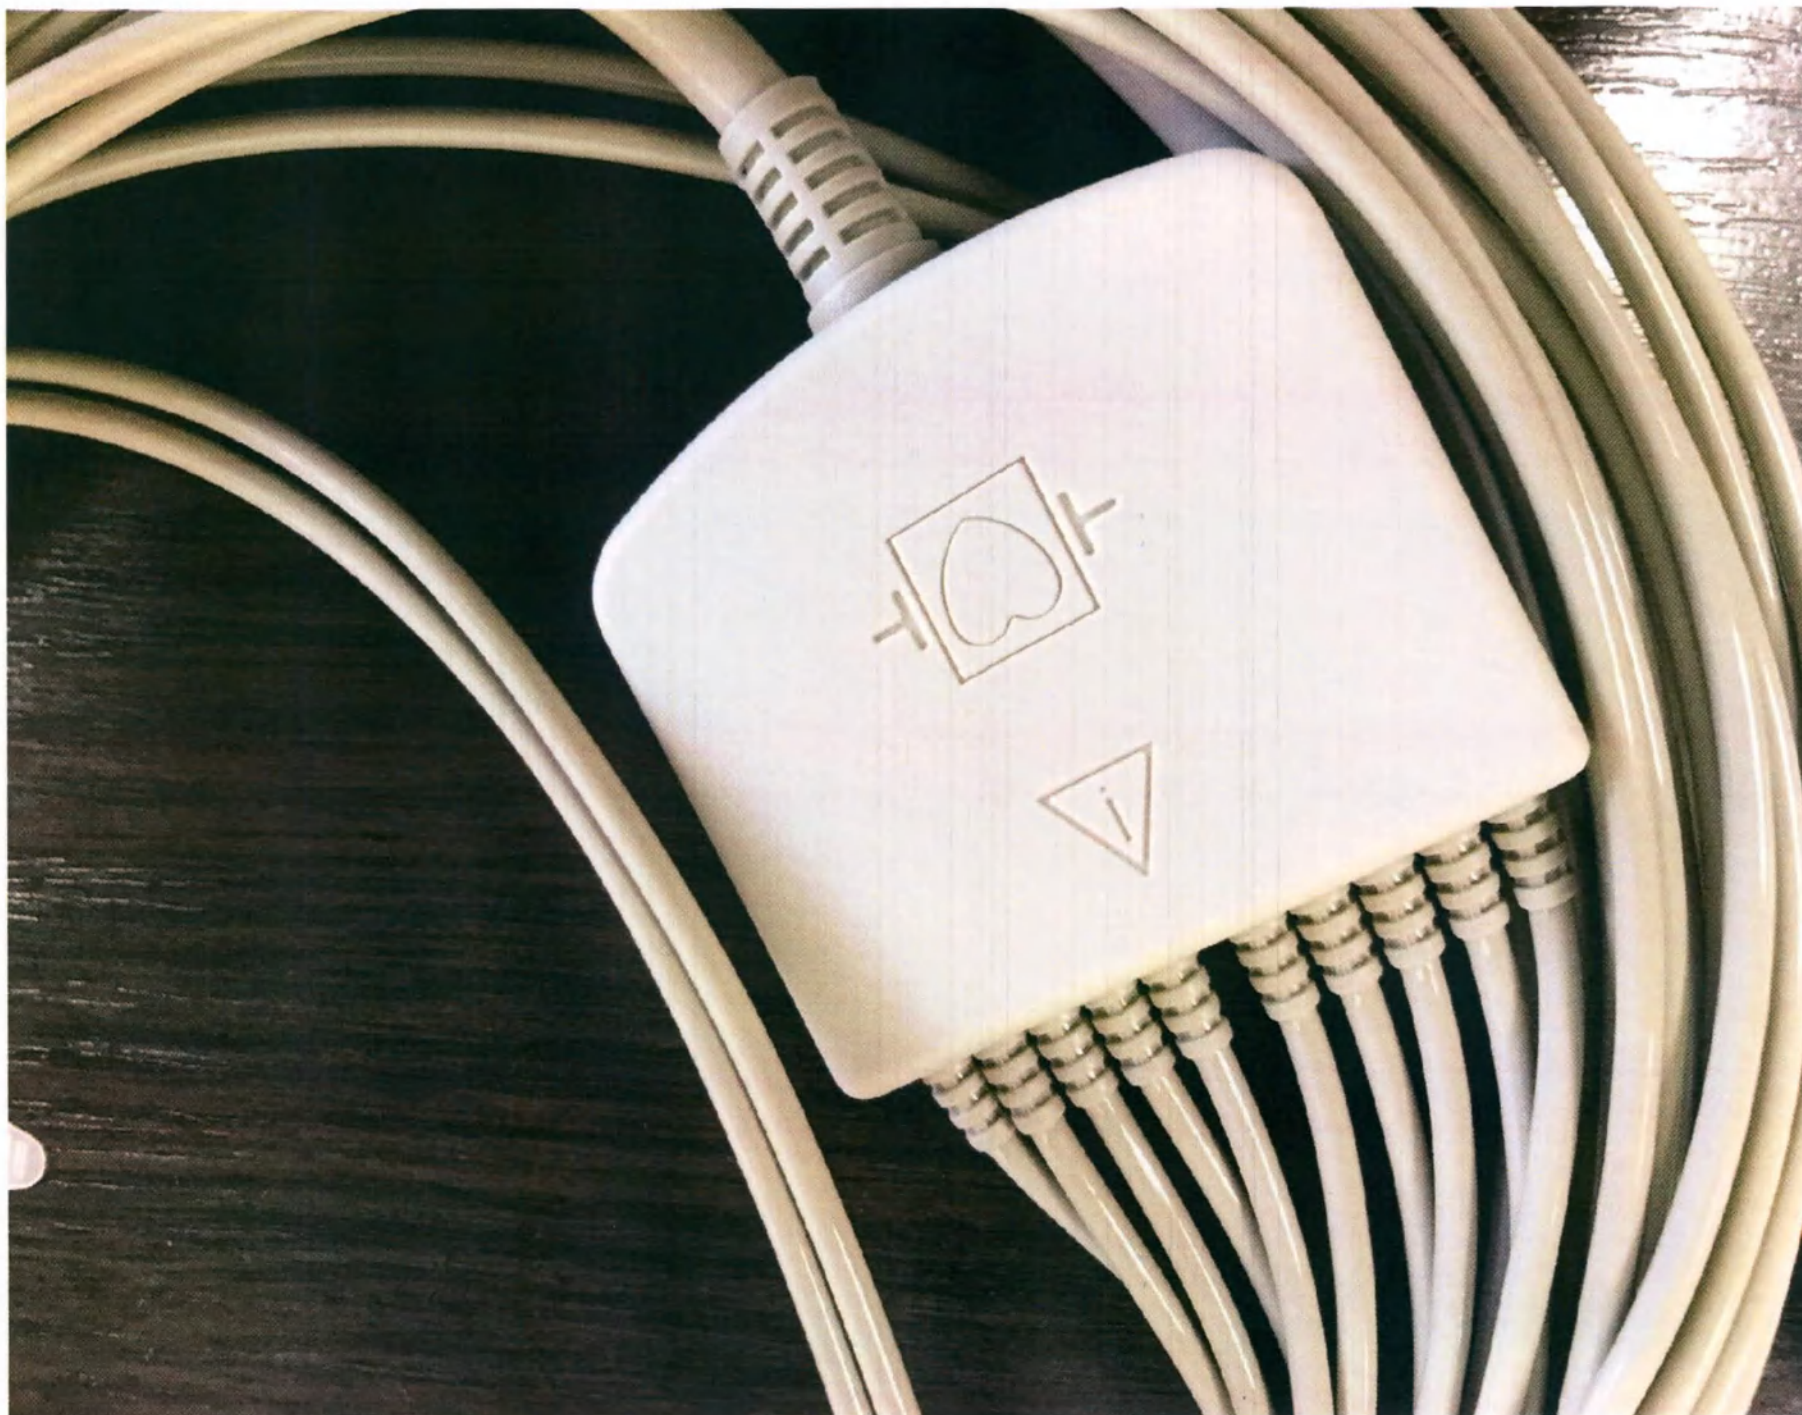

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (маркировка разъема отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (наклейка с серийным номером)

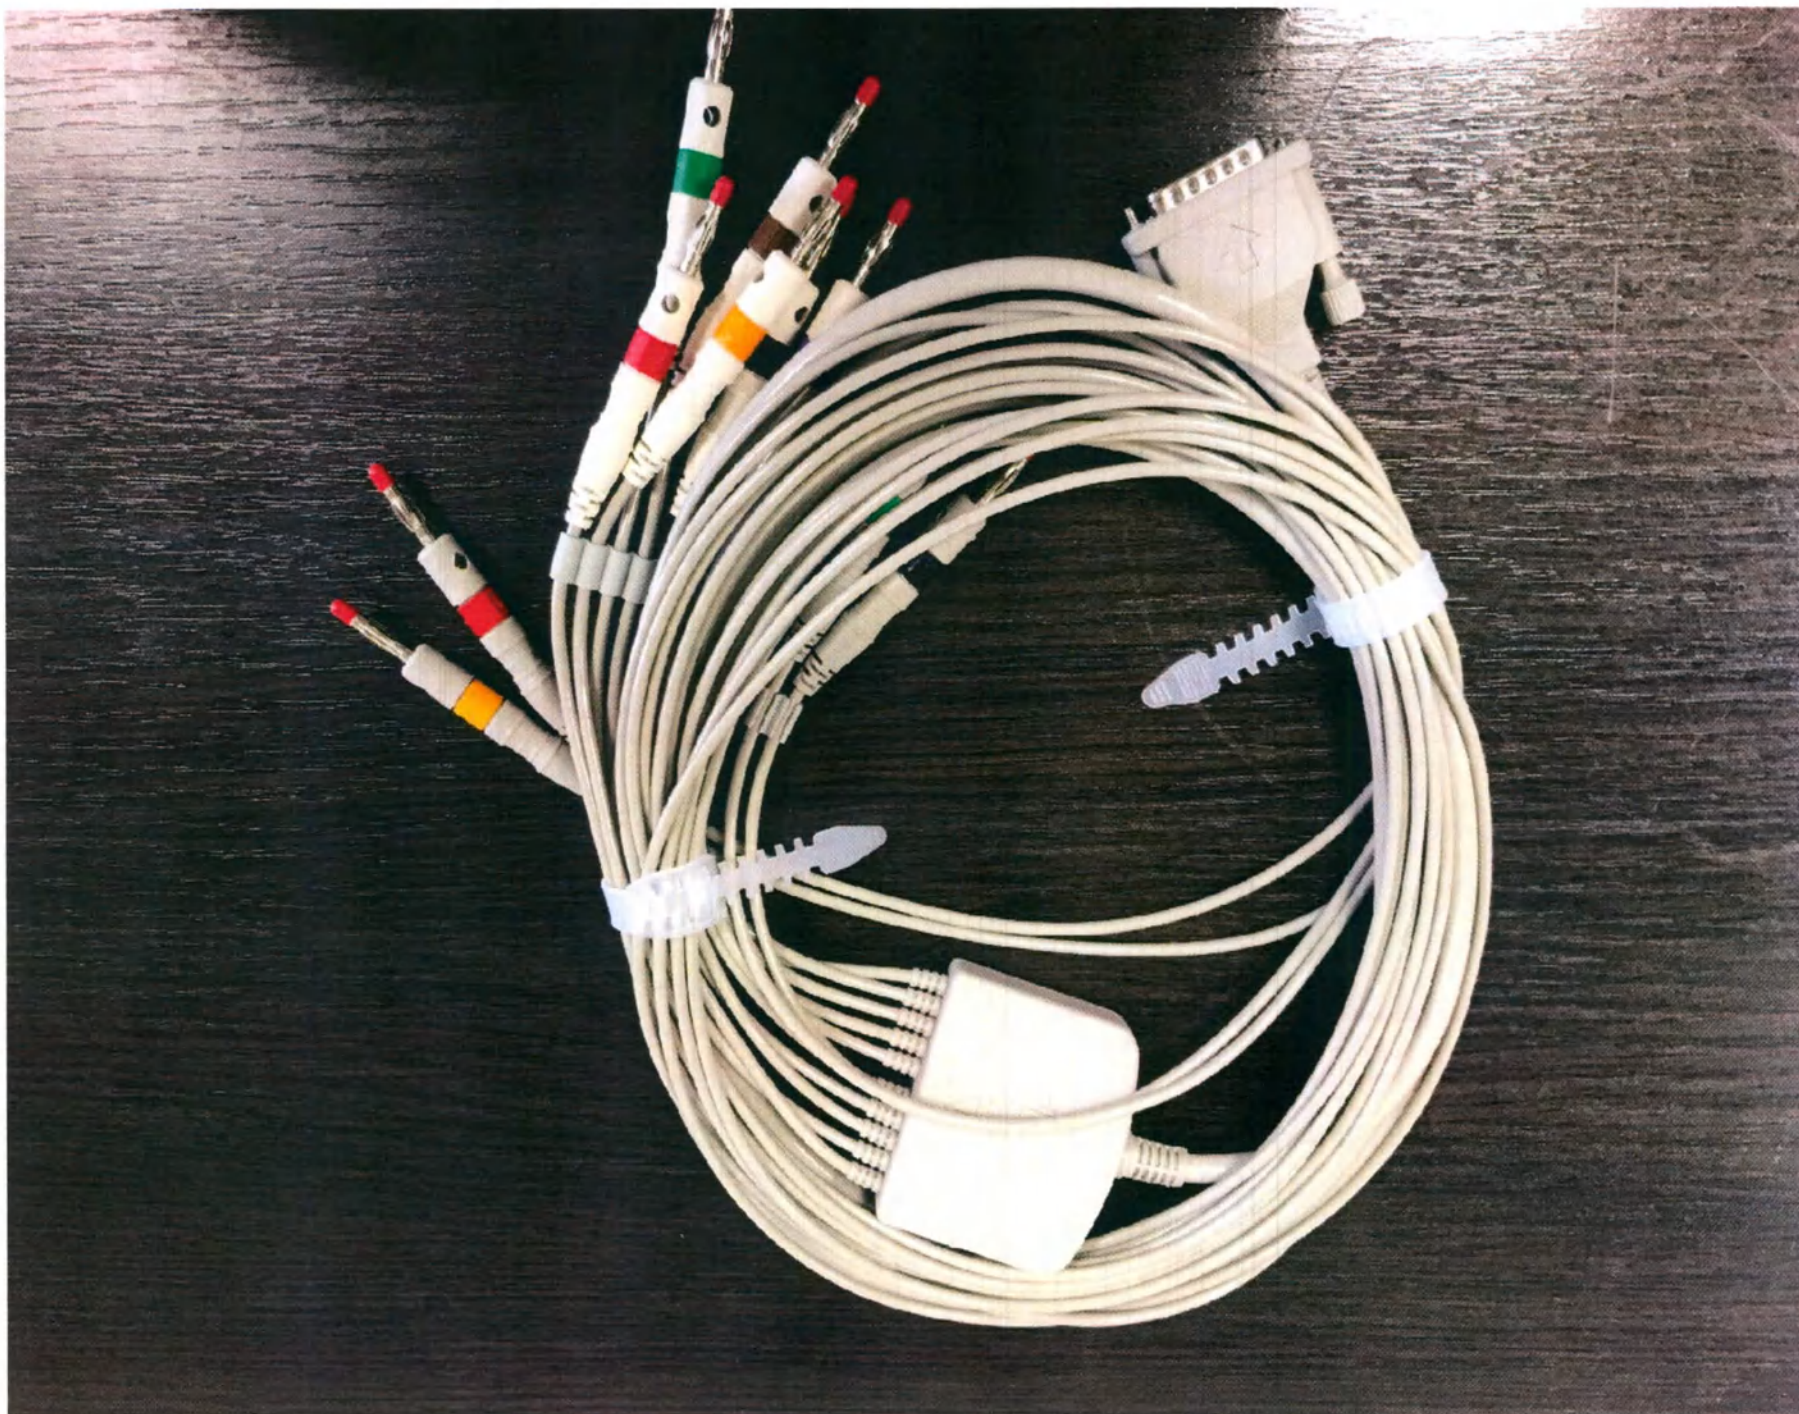

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (общий вид)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (разъем отведений)

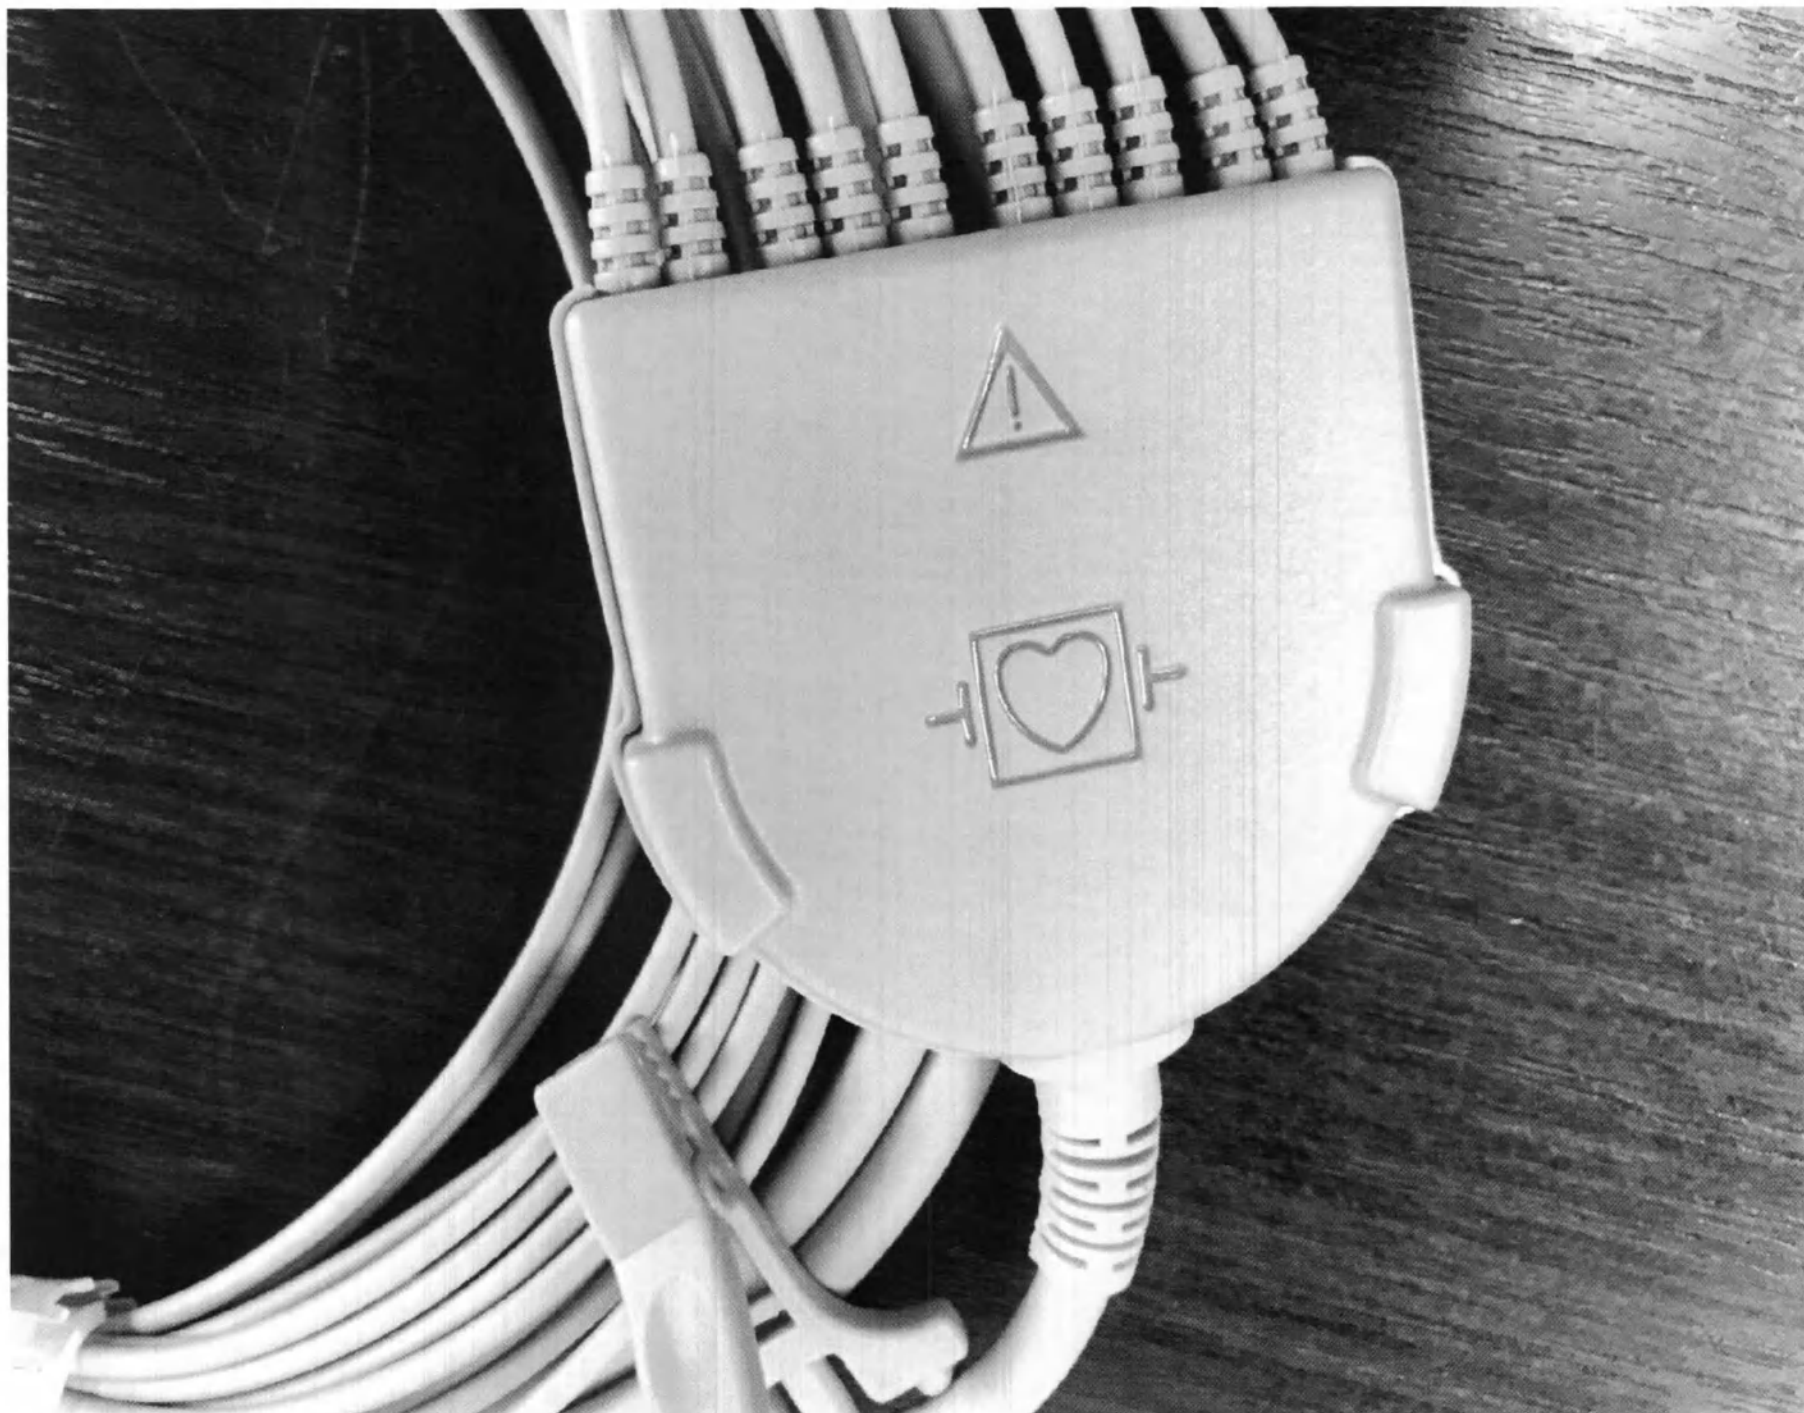

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (маркировка разъема отведений)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (наклейка с серийным номером)



Электрод-клипса для детей (в упаковке)



Электрод-клипса для детей (общий вид)




Электрод-клипса для детей (общий вид сбоку)



LOT ZH22040452211250029

 25.11.2022

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 1
Количество в упаковке – 4 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид)

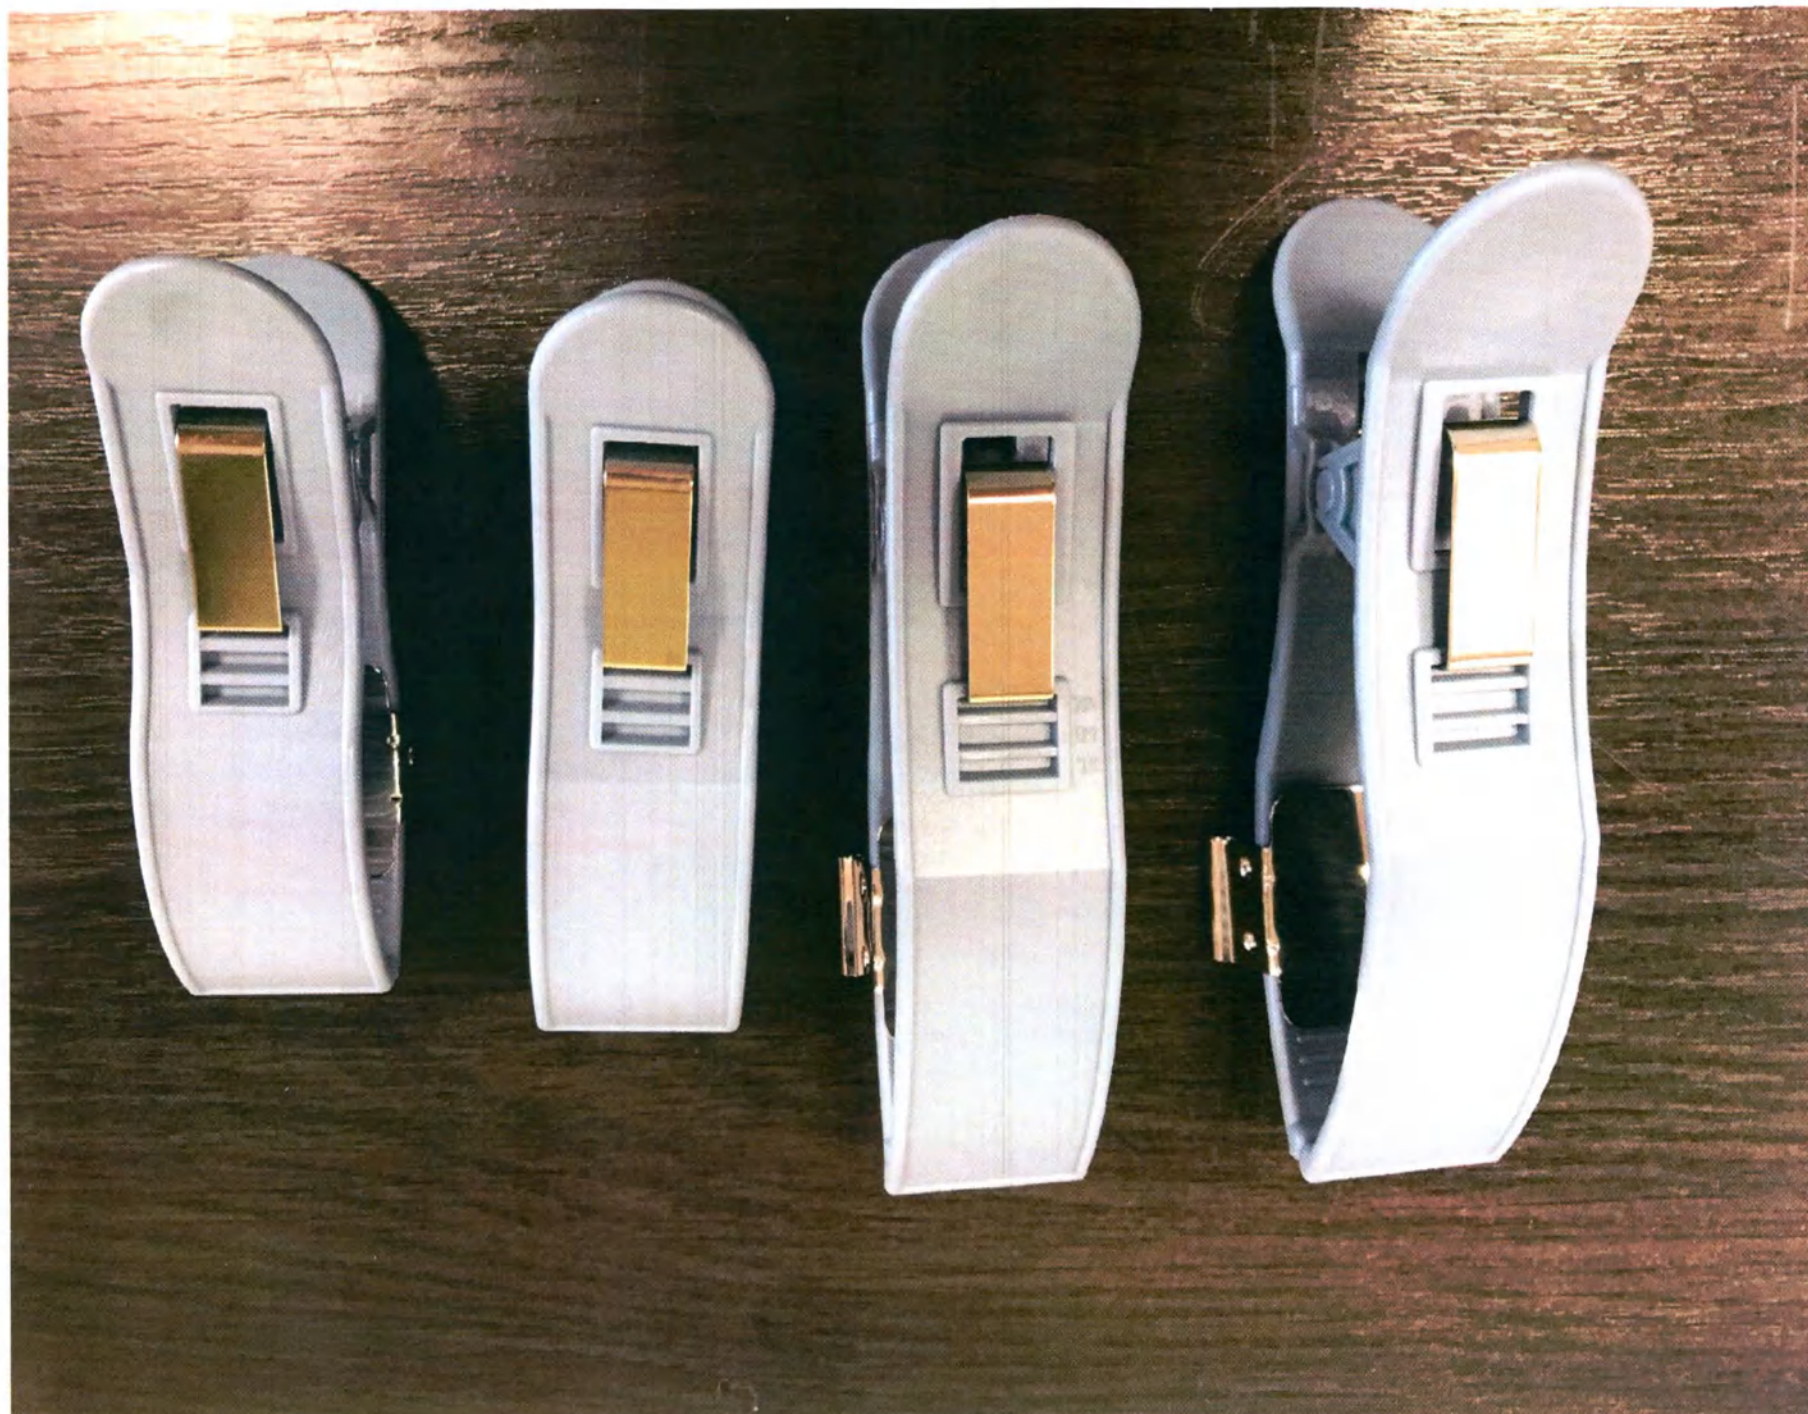

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид сбоку)



LOT 20230222-866

 22.02.2023

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 2
Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 2 (общий вид)




Электрод-груша для детей (в упаковке)



Электрод-груша для детей (упаковка)



Электрод-груша для детей (общий вид)

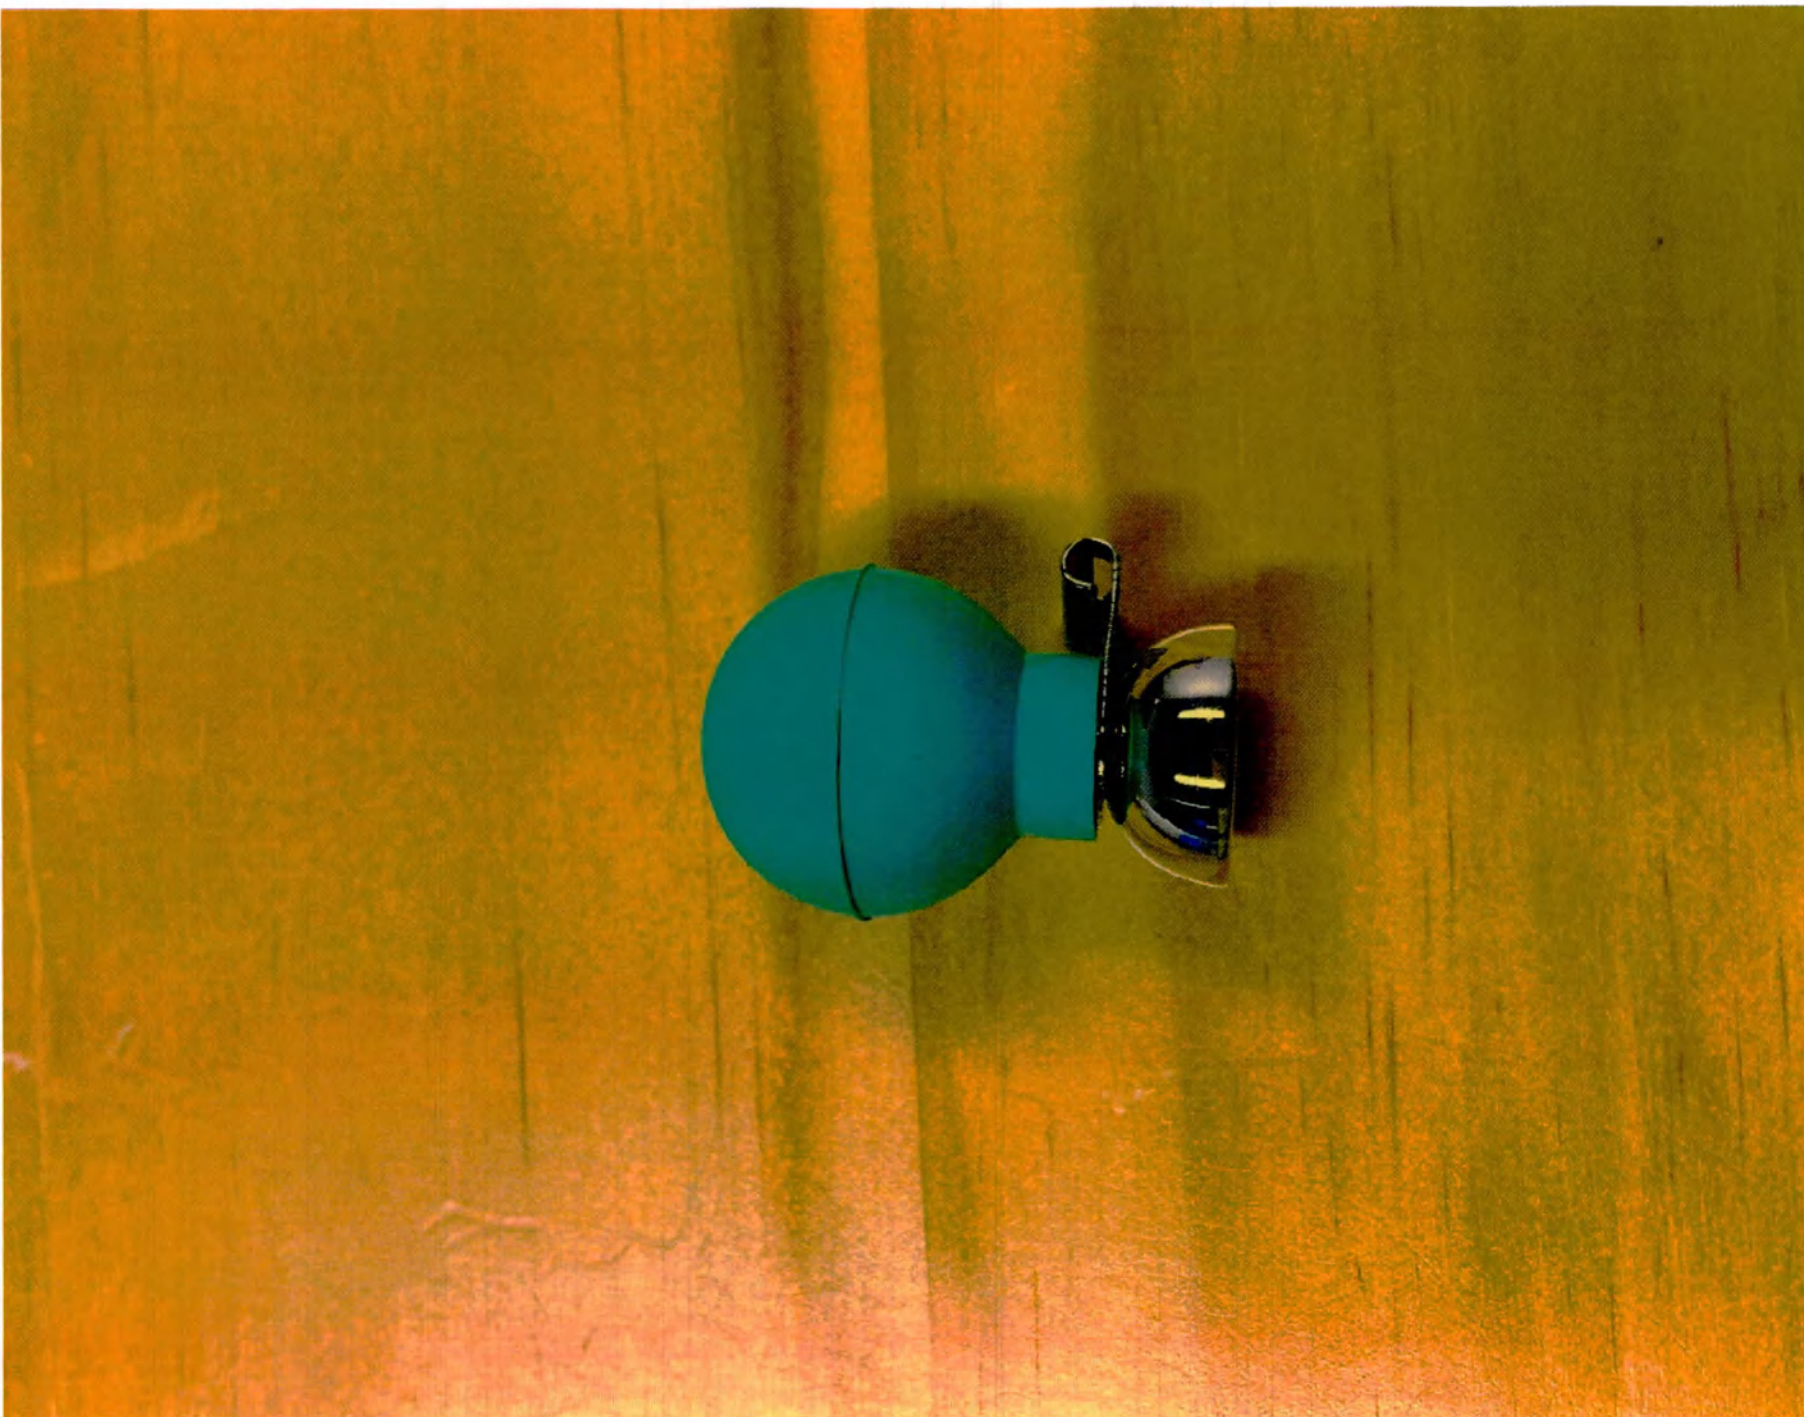


Электрод-груша для детей (общий вид)




Электрод-груша для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 1 (общий вид)

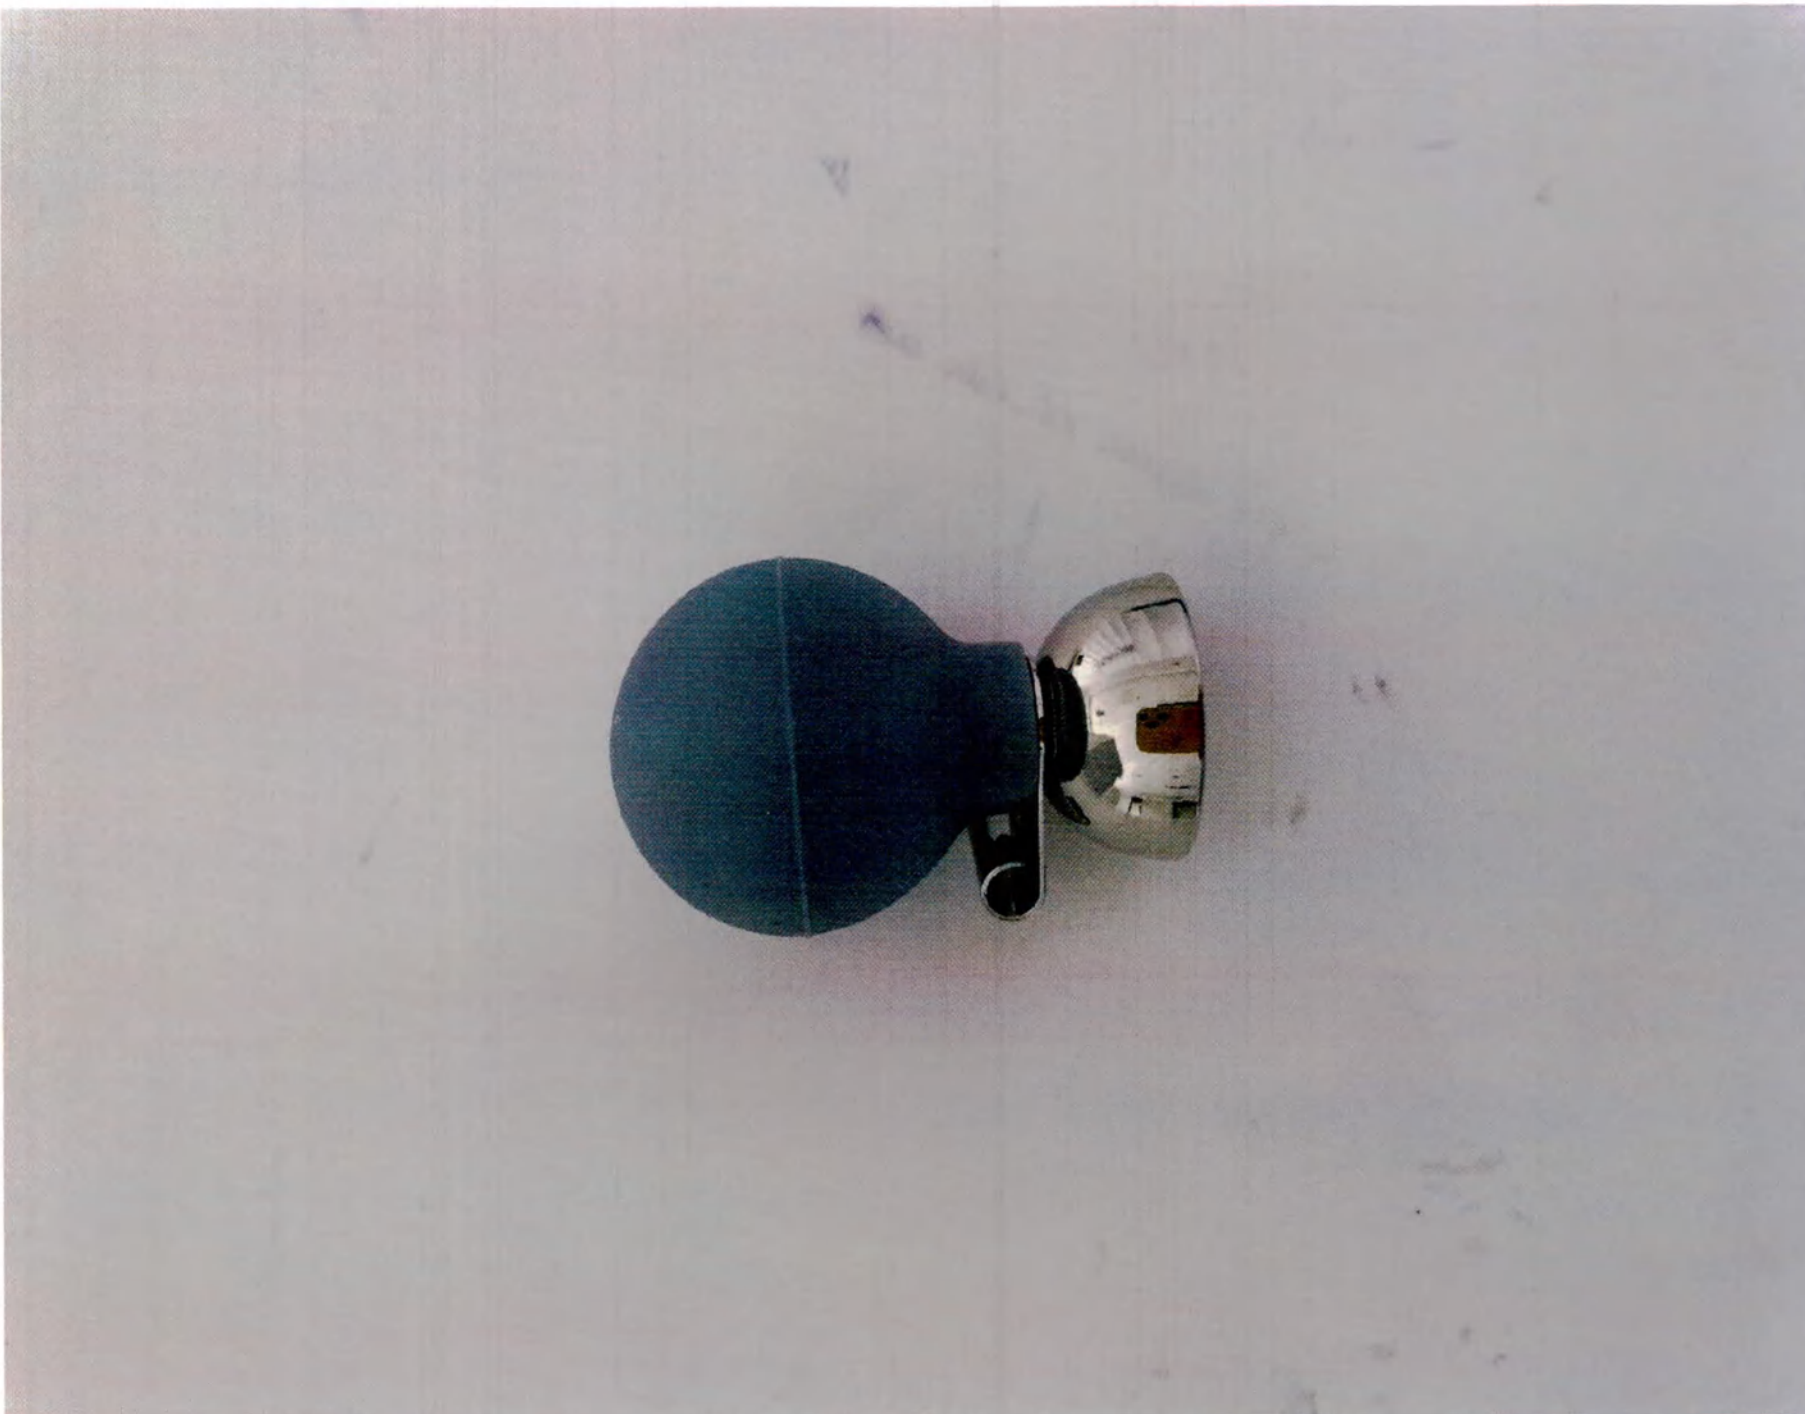

Электрод-груша для взрослых тип 1

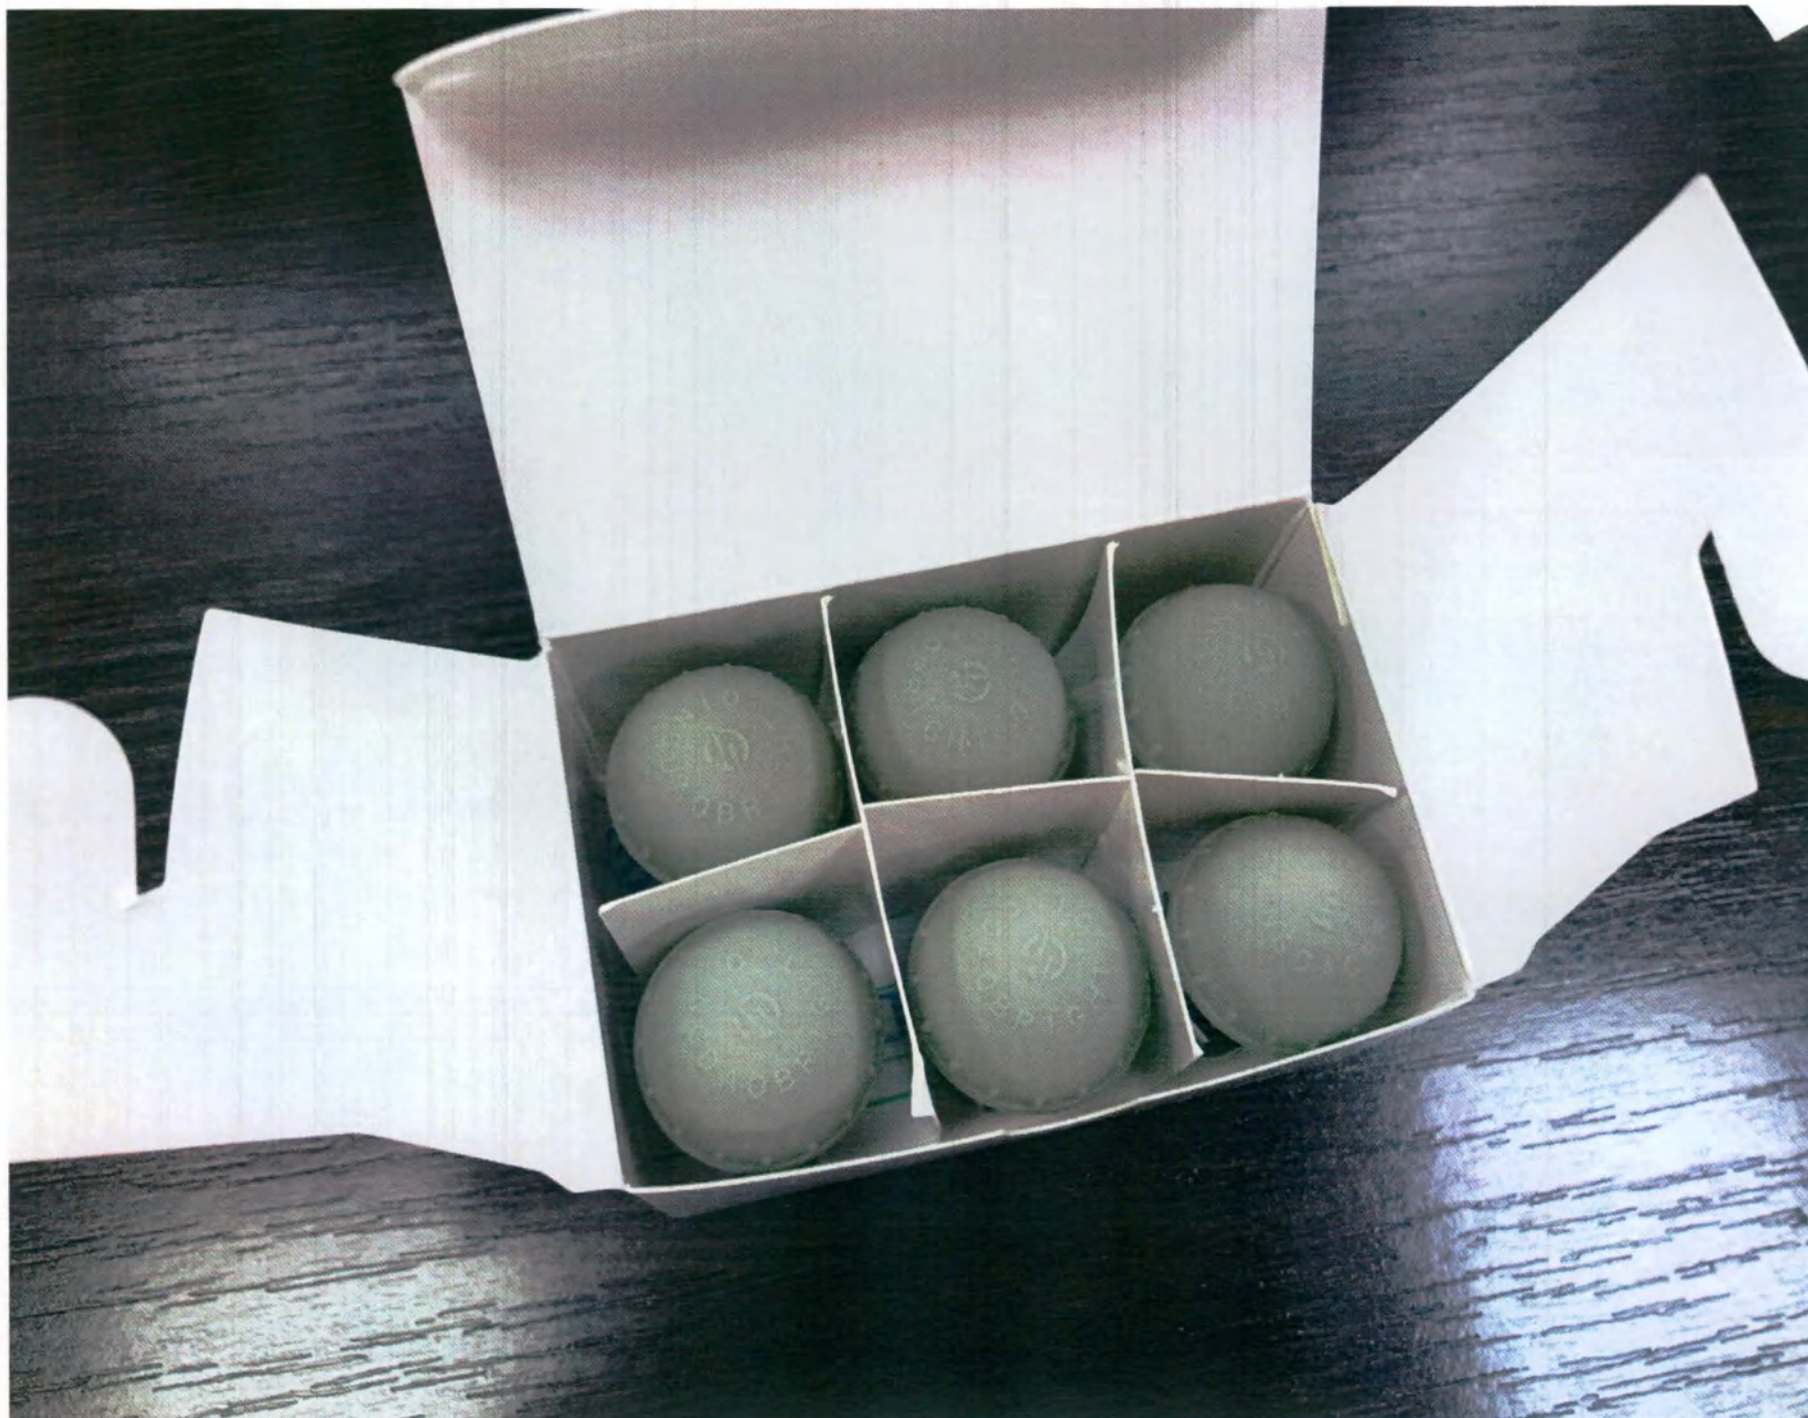

Электрод-груша для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 2 (общий вид)



Электрод-груша для взрослых тип 2

LOT

22110400017



30.10.2022

COMEN**Электрод-клипса для детей**

Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China


Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,


ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,

ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.


Регистрационное удостоверение №

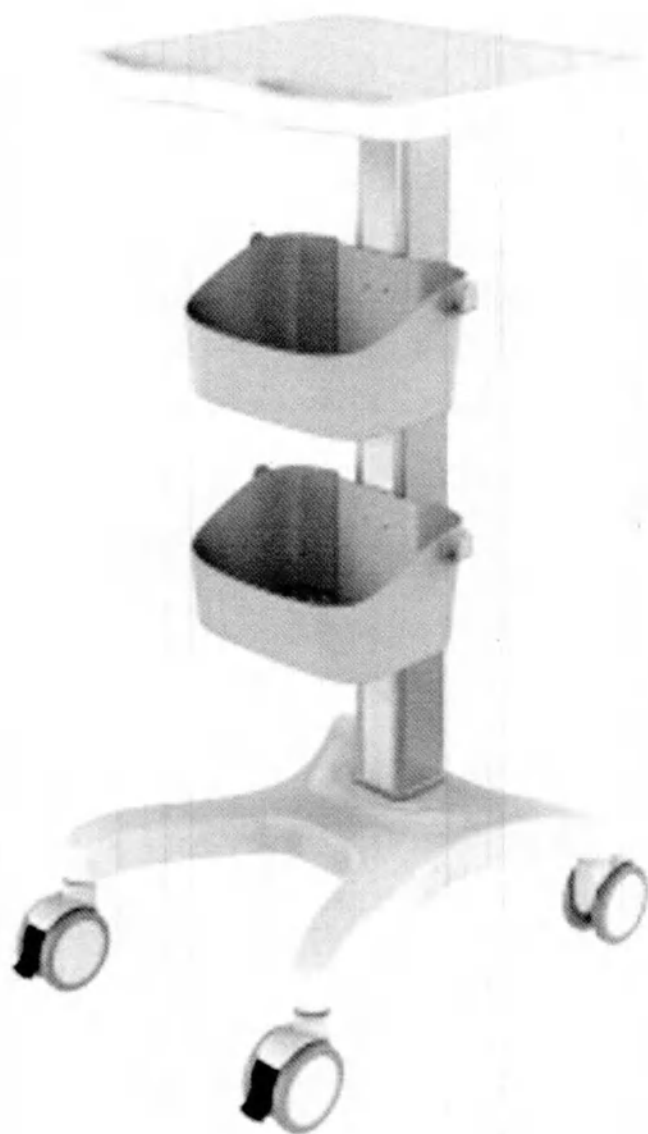


Тележка для ЭКГ модели CM1200A

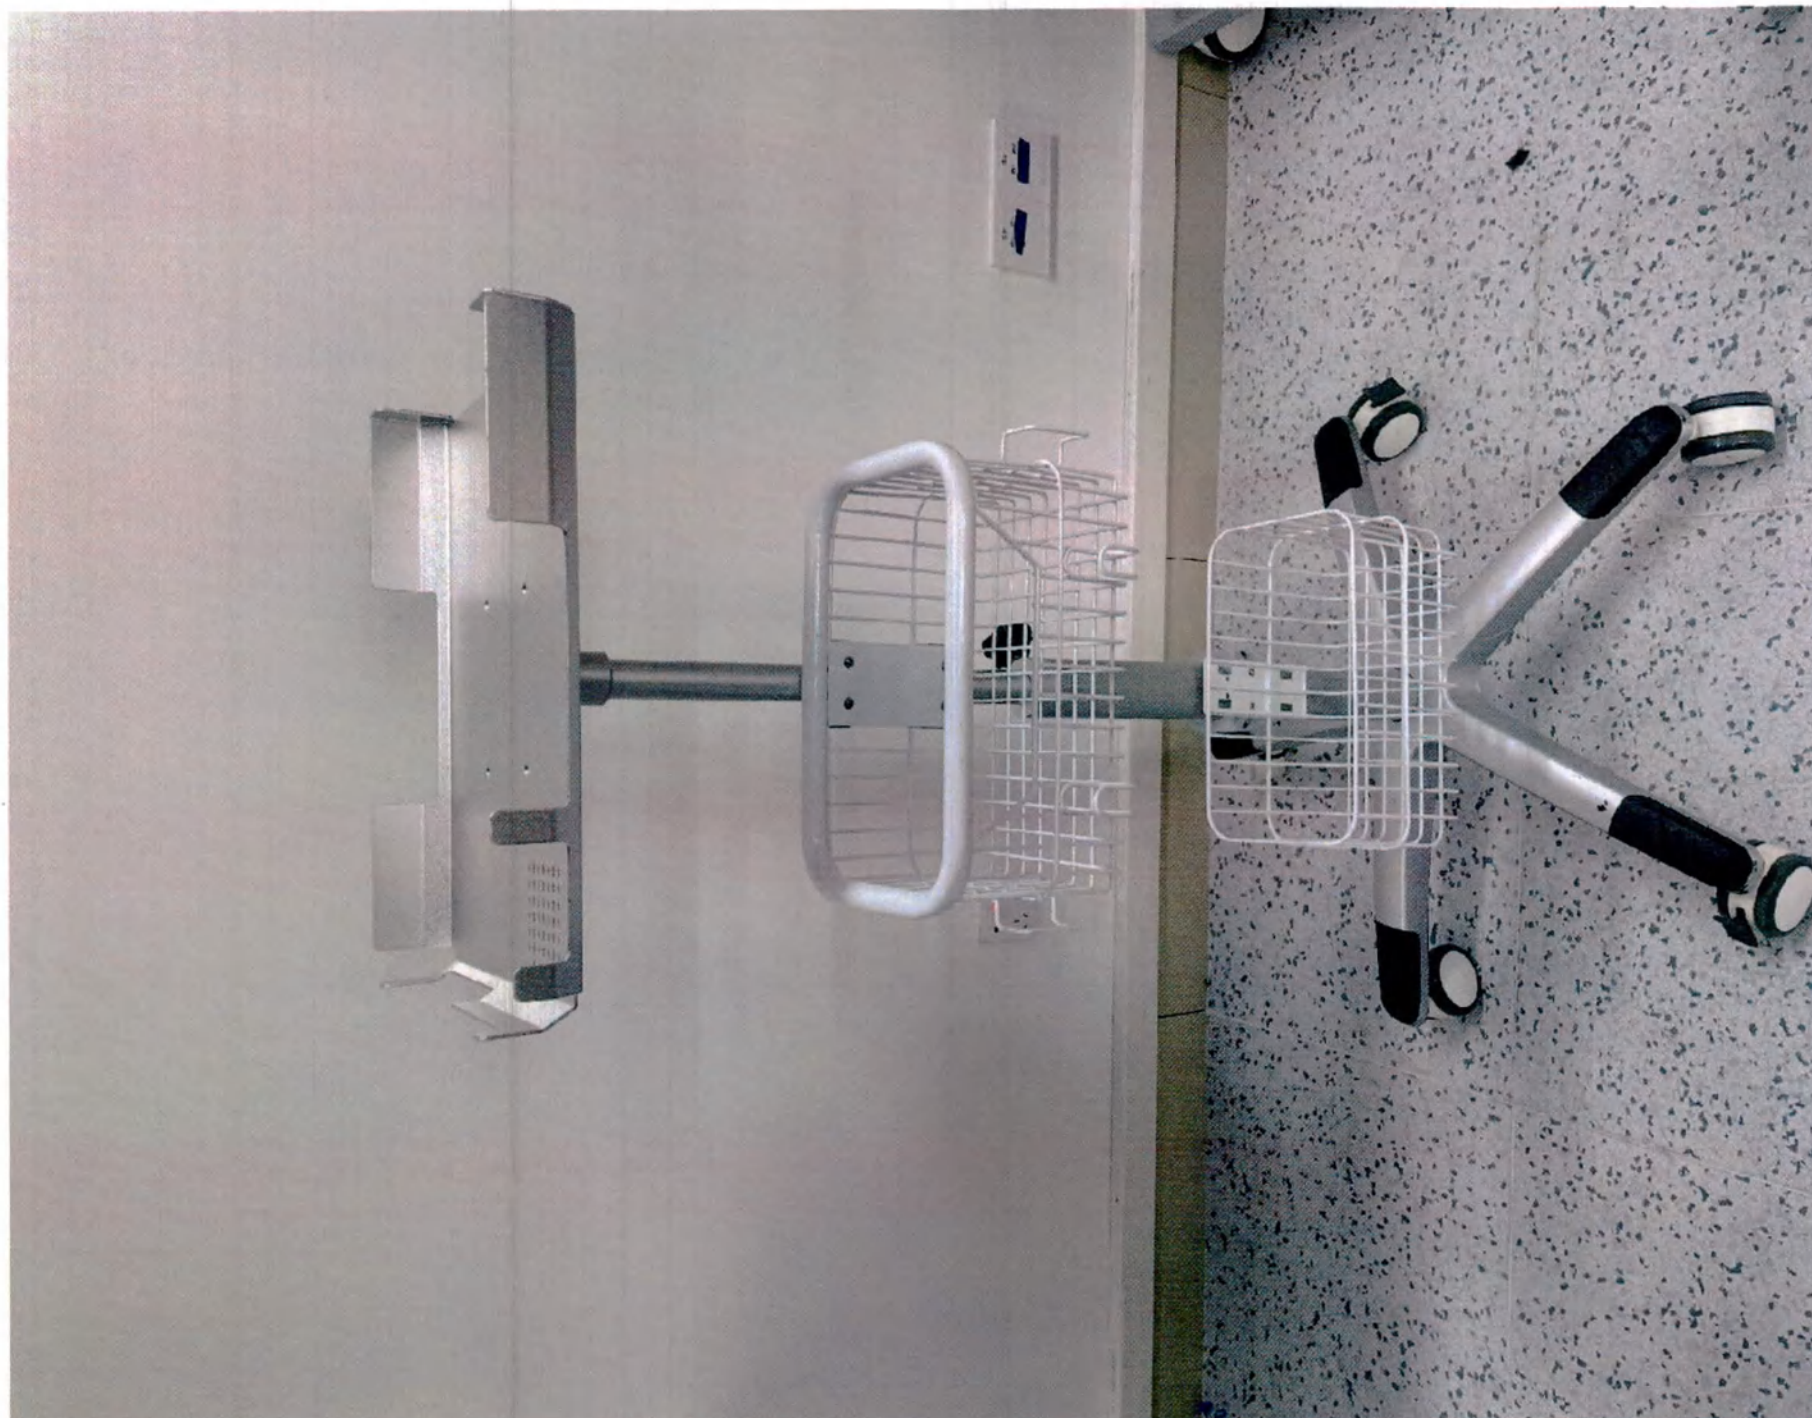

Тележка универсальная

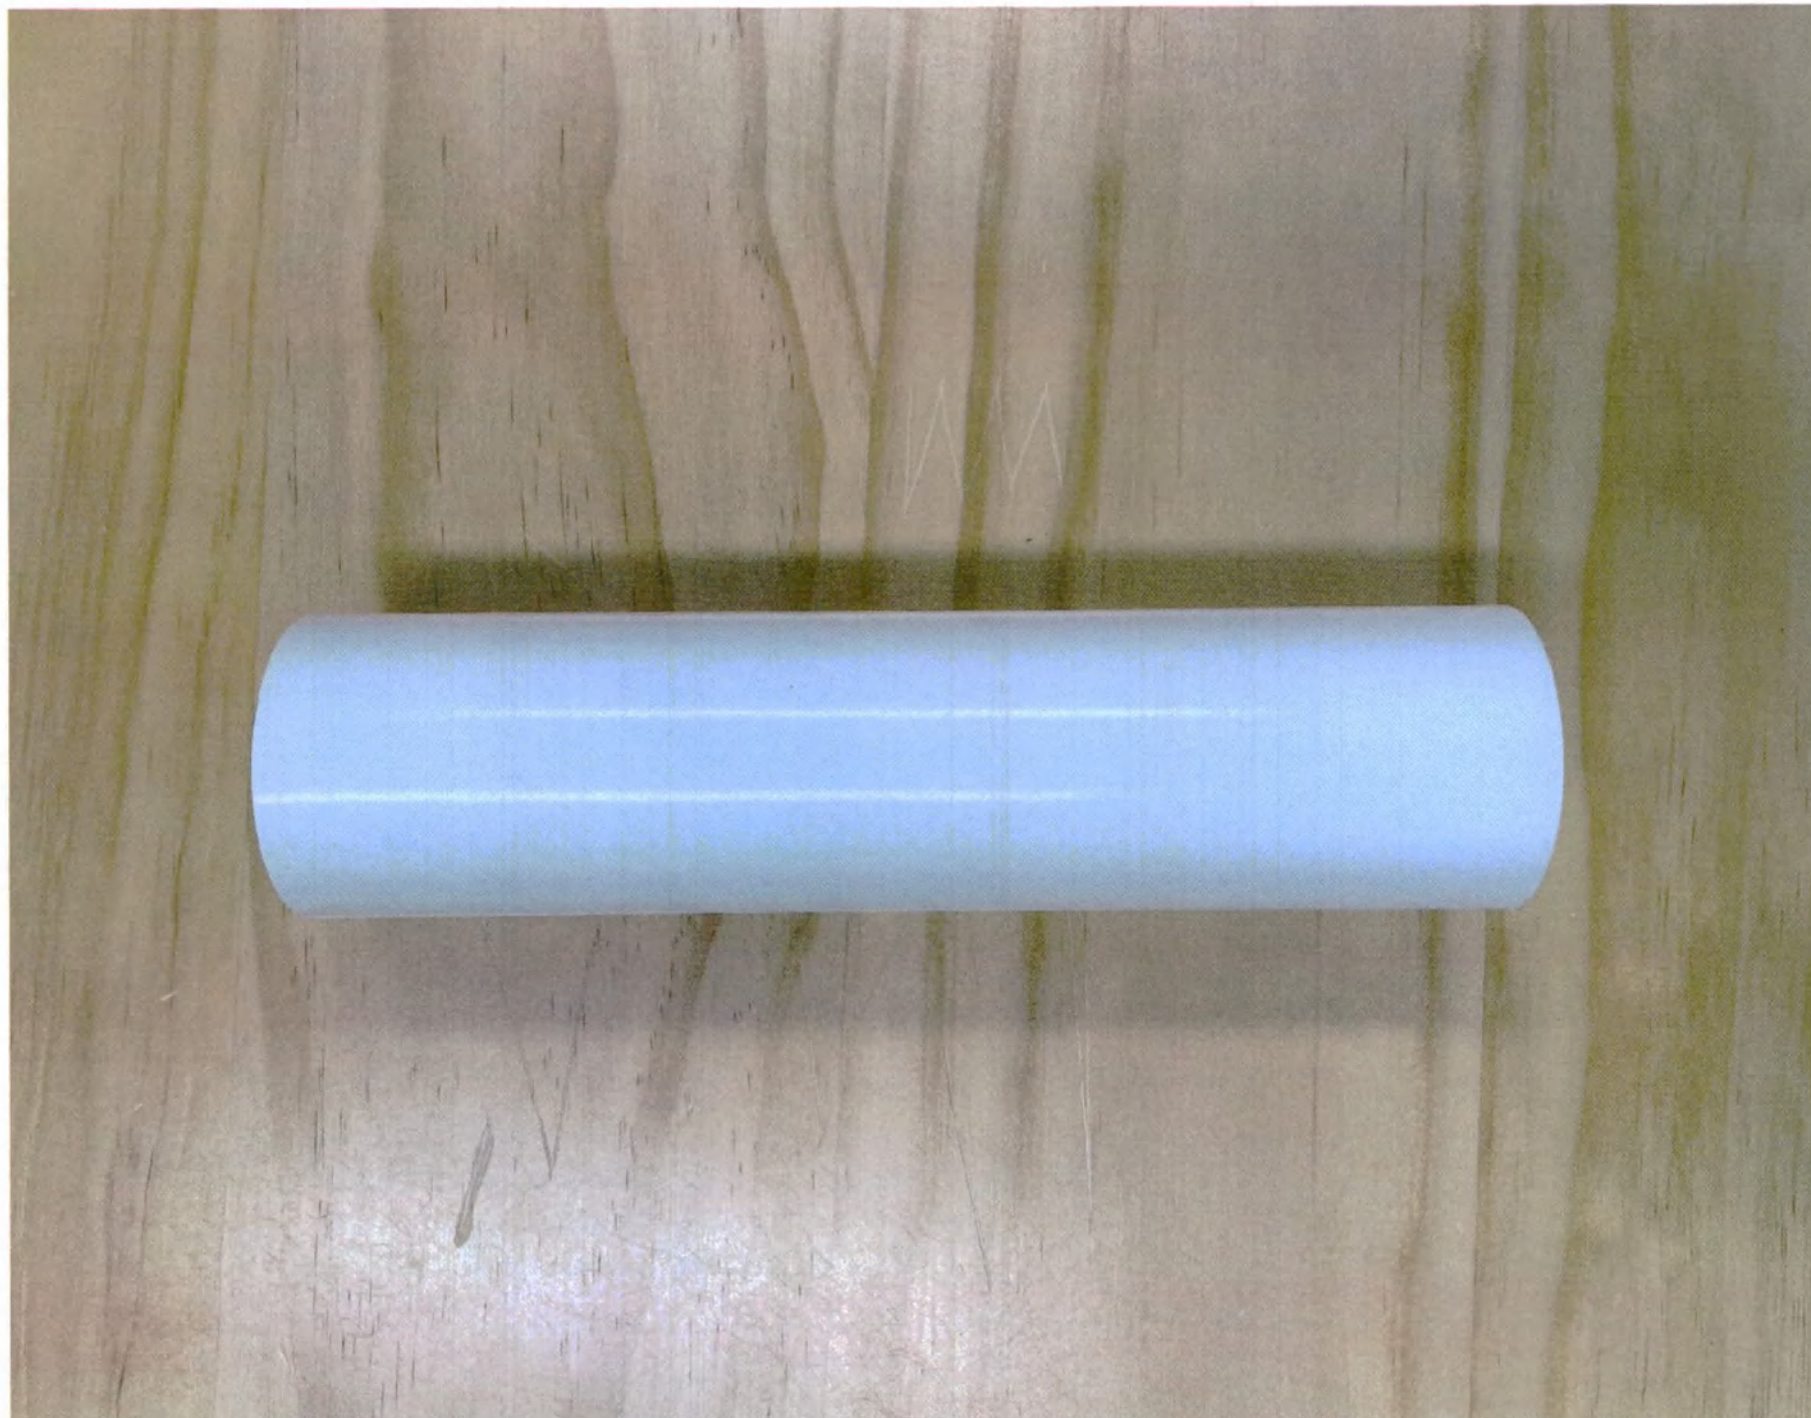

Бумага для печати для моделей CM1200A, CM1200B

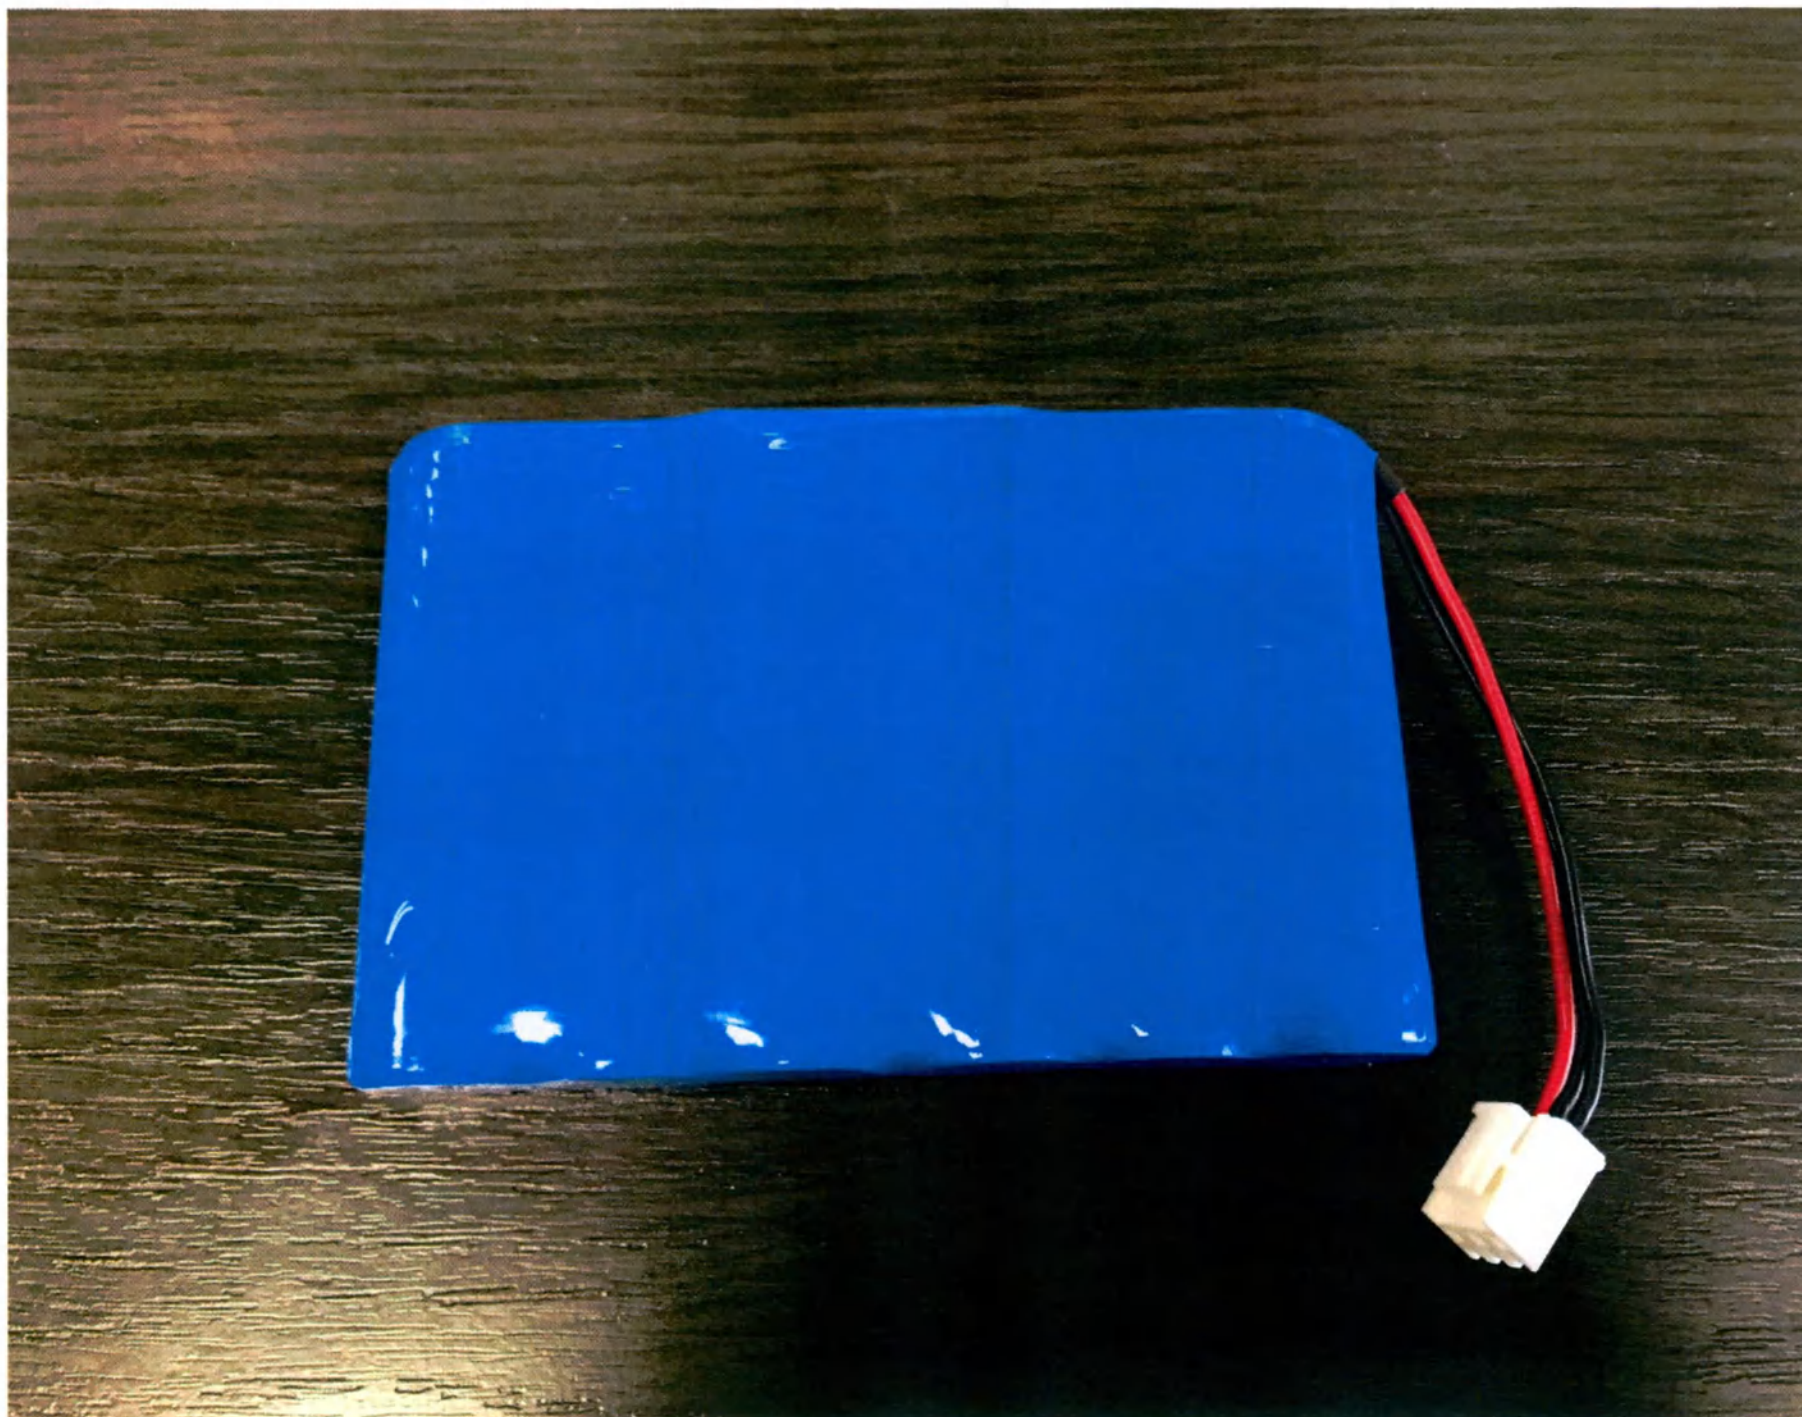

Батарея литиевая для модели CM1200A (общий вид)

可充电锂离子电池
Rechargeable Li-ion Battery

深圳市科曼医疗设备有限公司
SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Model: 022-000124-00
DC11. 1V $\approx$ 4400mAh/48Wh

MADE IN CHINA
中国制造



SHR122301202303040079

2023-03-04

警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在 -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。推荐使用的最高环境温度为 45°C (125°F)。


CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Don't crush, puncture, disassemble or short circuit the battery in -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use. Maximum Recommended Ambient is 45°C (125°F)

Батарея литиевая для модели CM1200A (маркировка)



Планка принтера фиксирующая для модели CM1200A

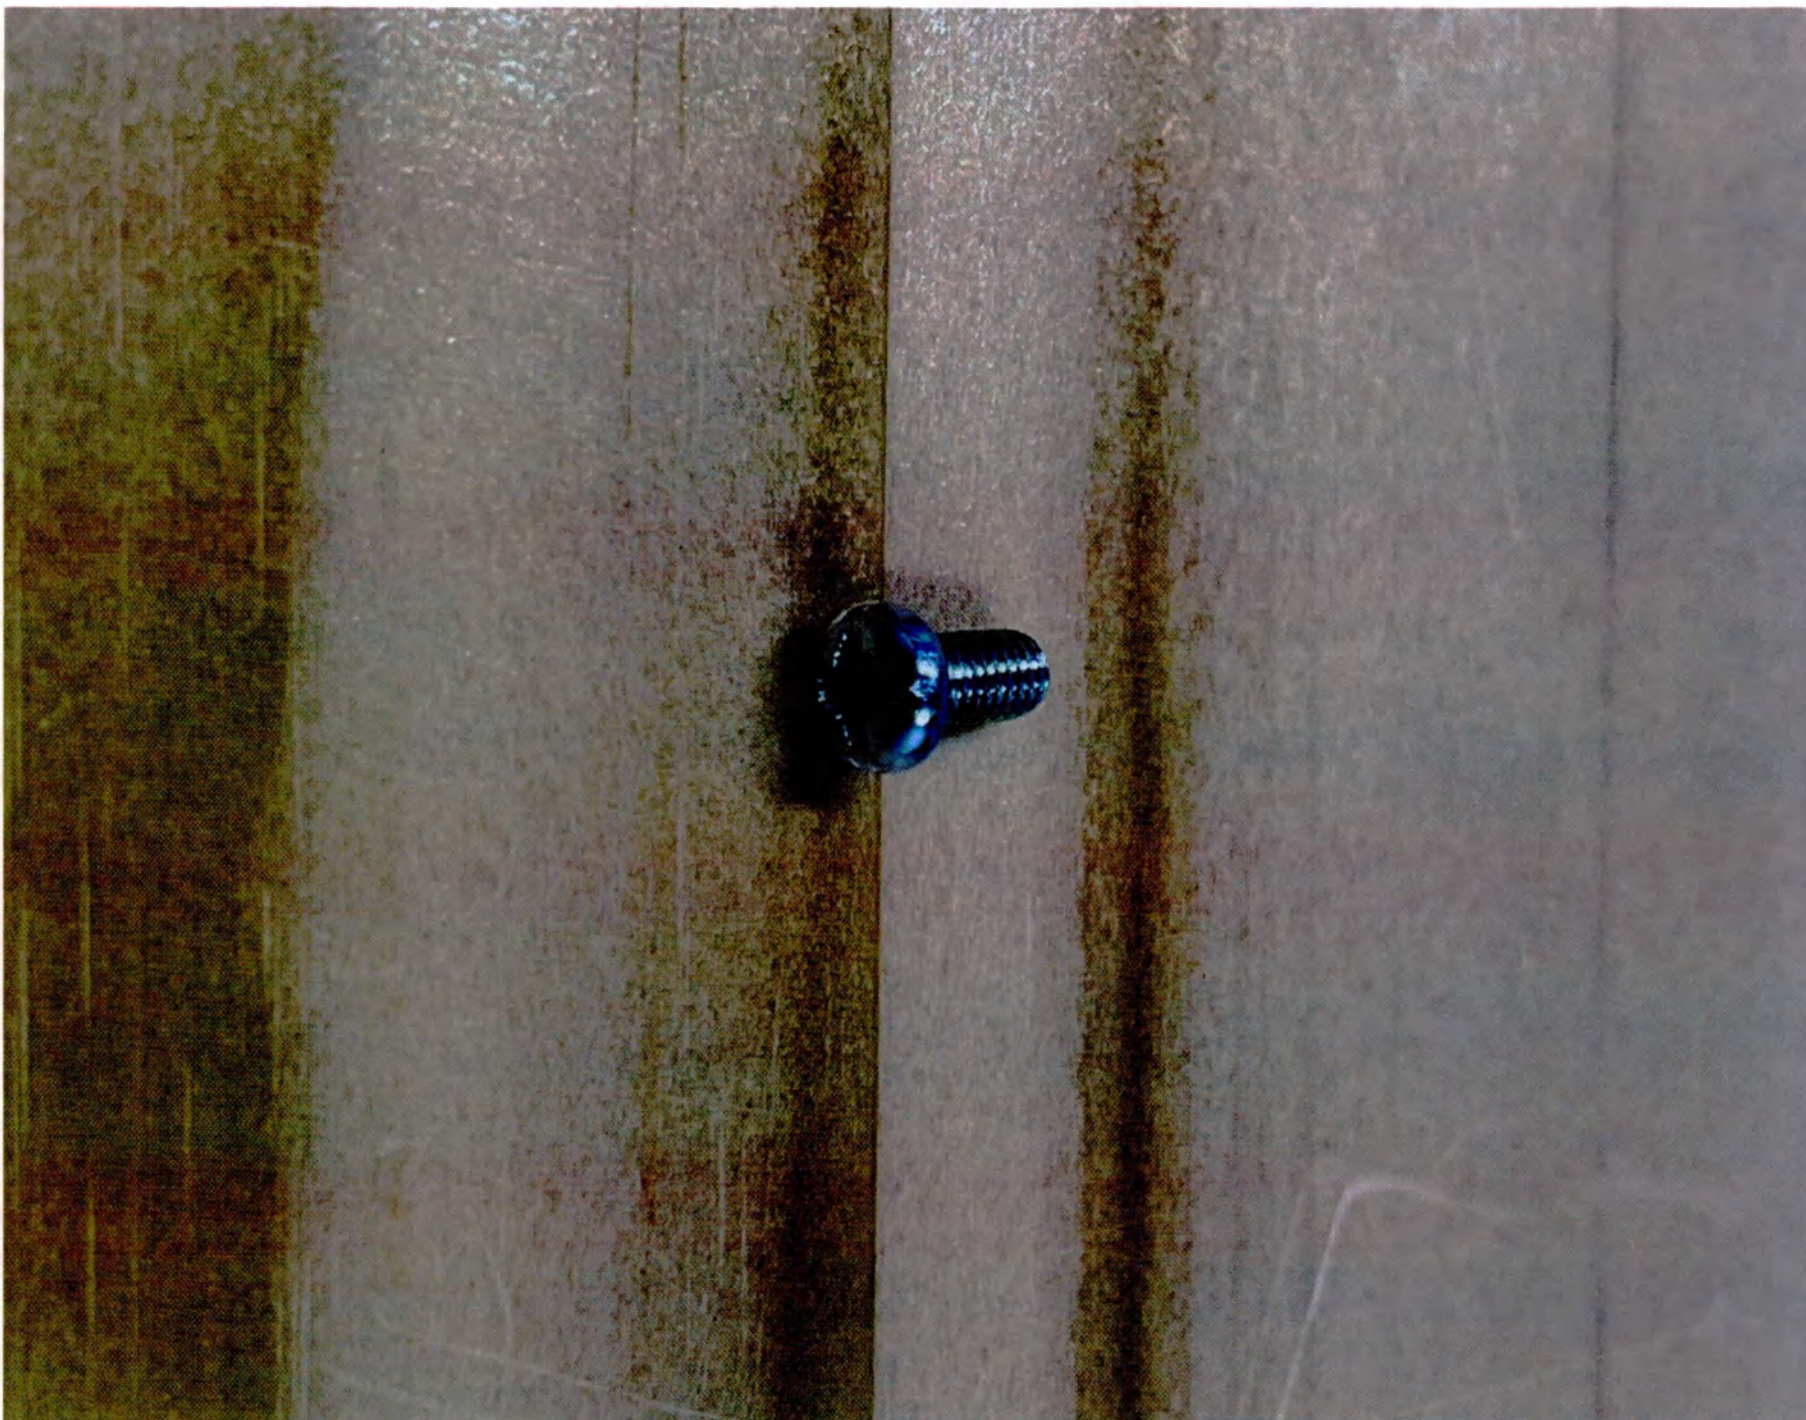


Винты крепежные

Электрокардиограф CM1200B



Электрокардиограф СМ1200В: транспортная/потребительская коробка

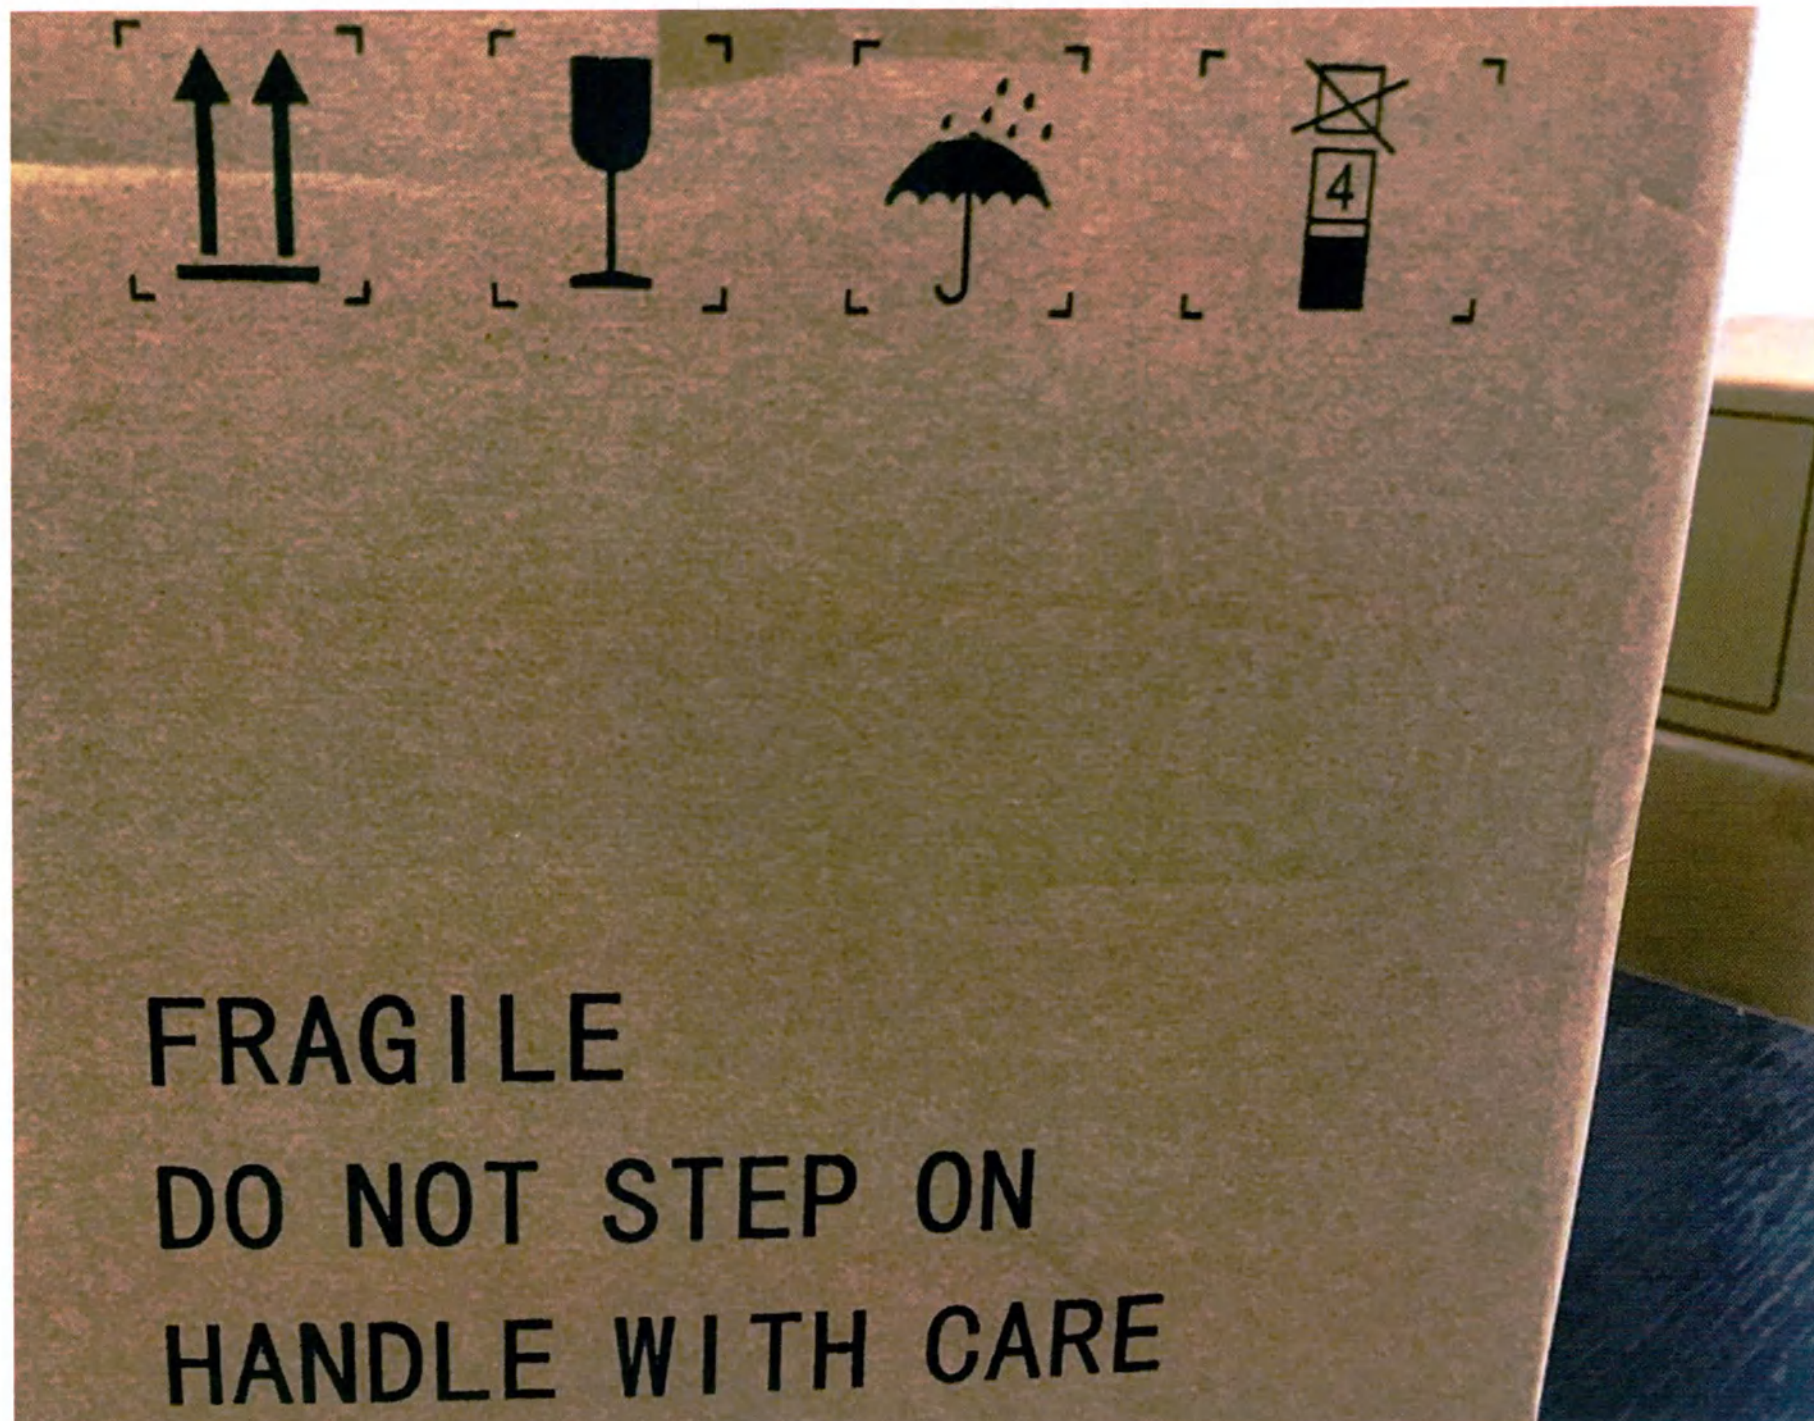

Электрокардиограф CM1200B: манипуляционные надписи и знаки на транспортной/потребительской коробке

MODEL: CM1200B

DATE: 2022.09.27

NUMBER: 92220926006

ORDER NO#: FG20220917



92220926006

Электрокардиограф CM1200B: идентификационная наклейка на транспортной/потребительской коробке

COMEN

Электрокардиограф CM1200B

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Размер упаковки: 445мм (длина)х 290мм (глубина) х370мм (высота)

Масса нетто: 3,7 кг Масса брутто: 4,5 кг Количество в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.


(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.
6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMIT



HUMIDITY
LIMITATION




ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Электрокардиограф CM1200B: маркировка транспортной/потребительской коробки



Блок базовый CM1200B (в воздушных пакетах для предотвращения повреждений)

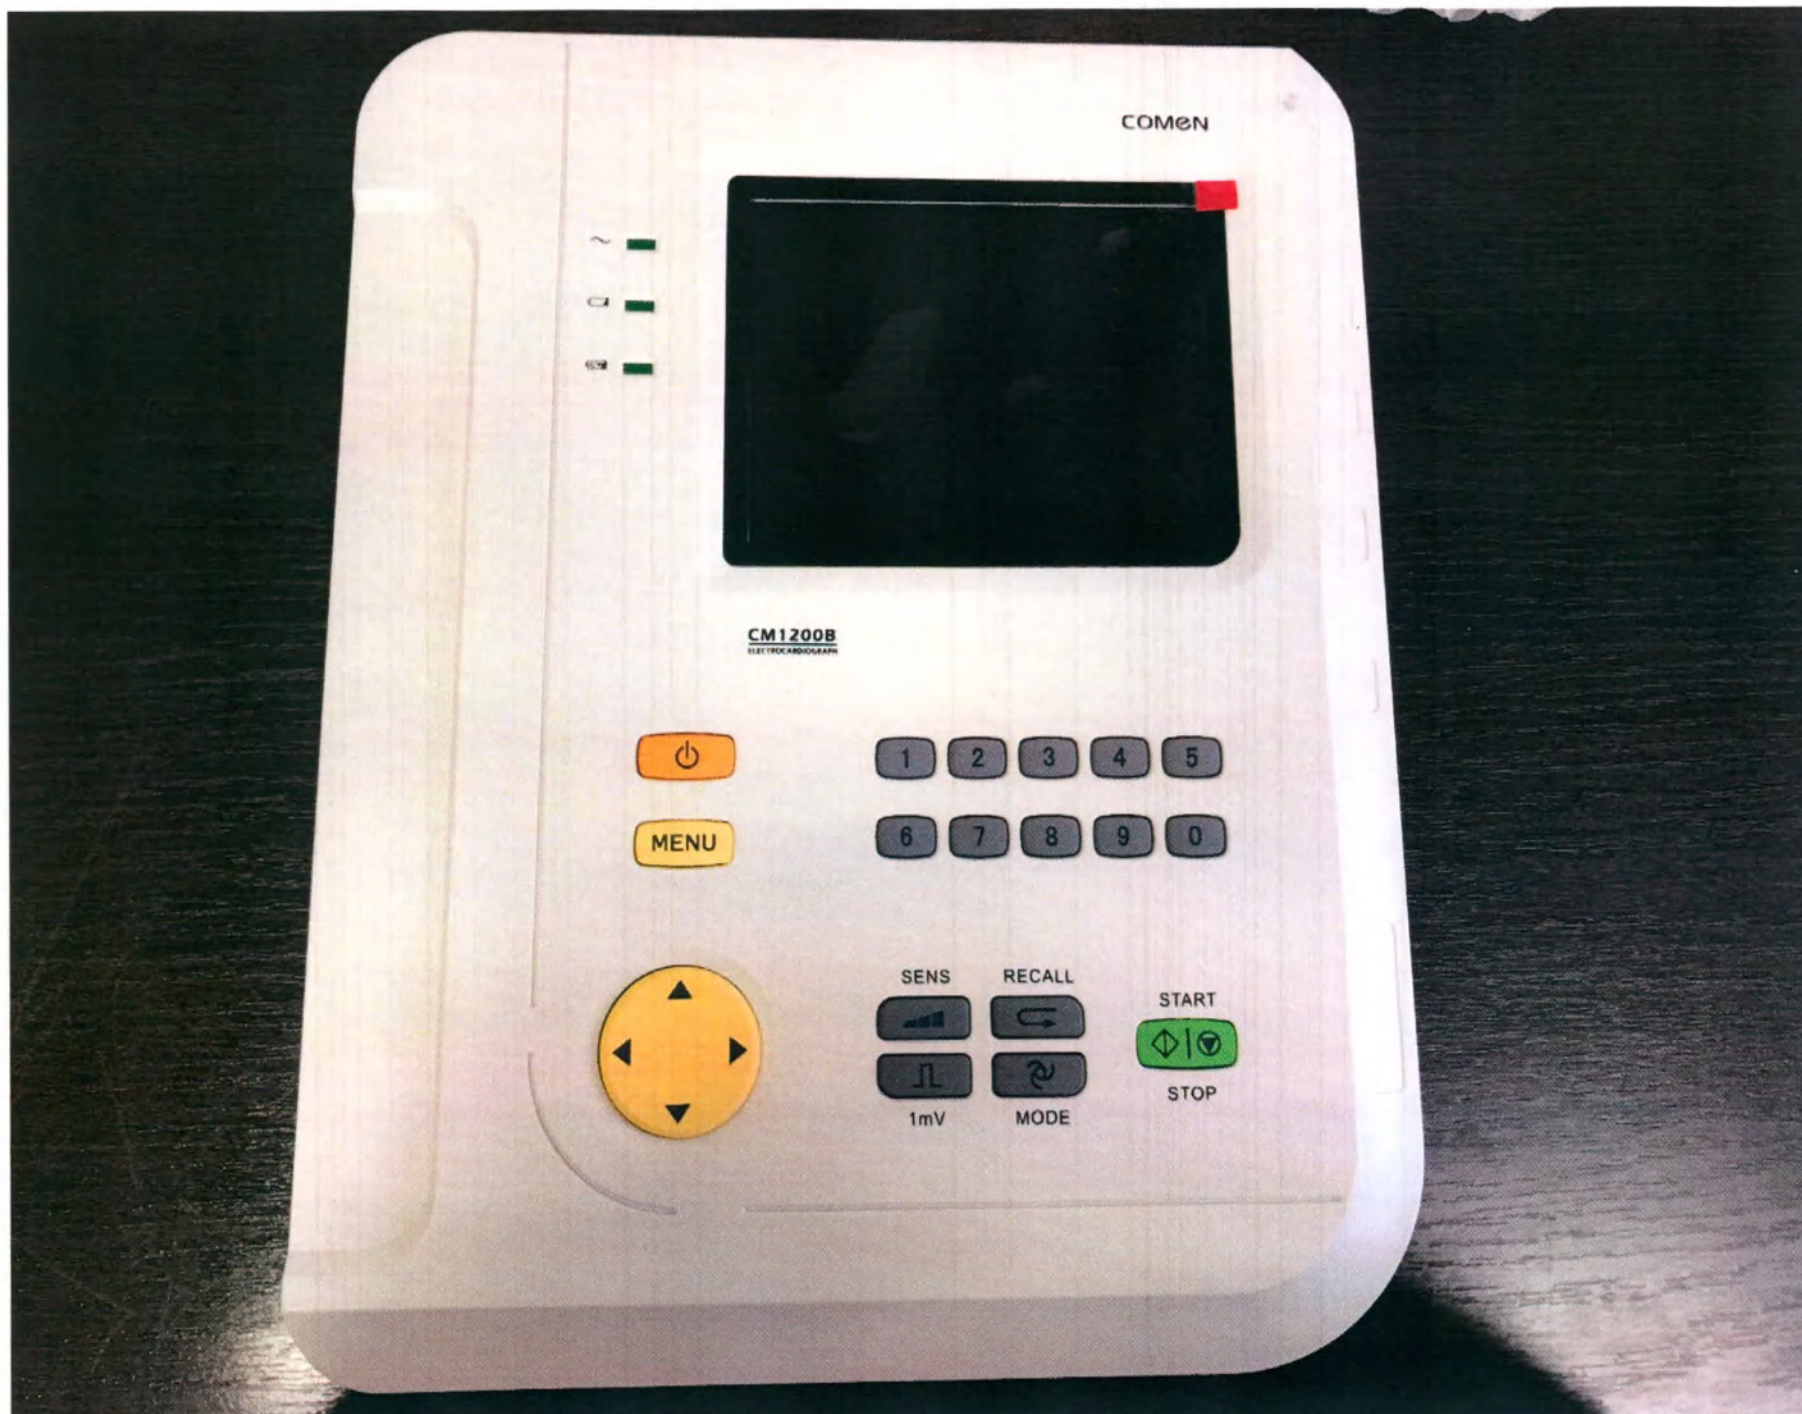

Блок базовый CM1200B (вид сверху, передняя панель)



Блок базовый CM1200B (вид сбоку)



Блок базовый CM1200В (вид сбоку, символы на панели)



Блок базовый CM1200В (вид сбоку, символы на панели)



Блок базовый CM1200В (вид сбоку)




Блок базовый CM1200B (вид сбоку, с открытым принтером)



Блок базовый CM1200В (вид снизу)



Блок базовый CM1200B (вид сверху)

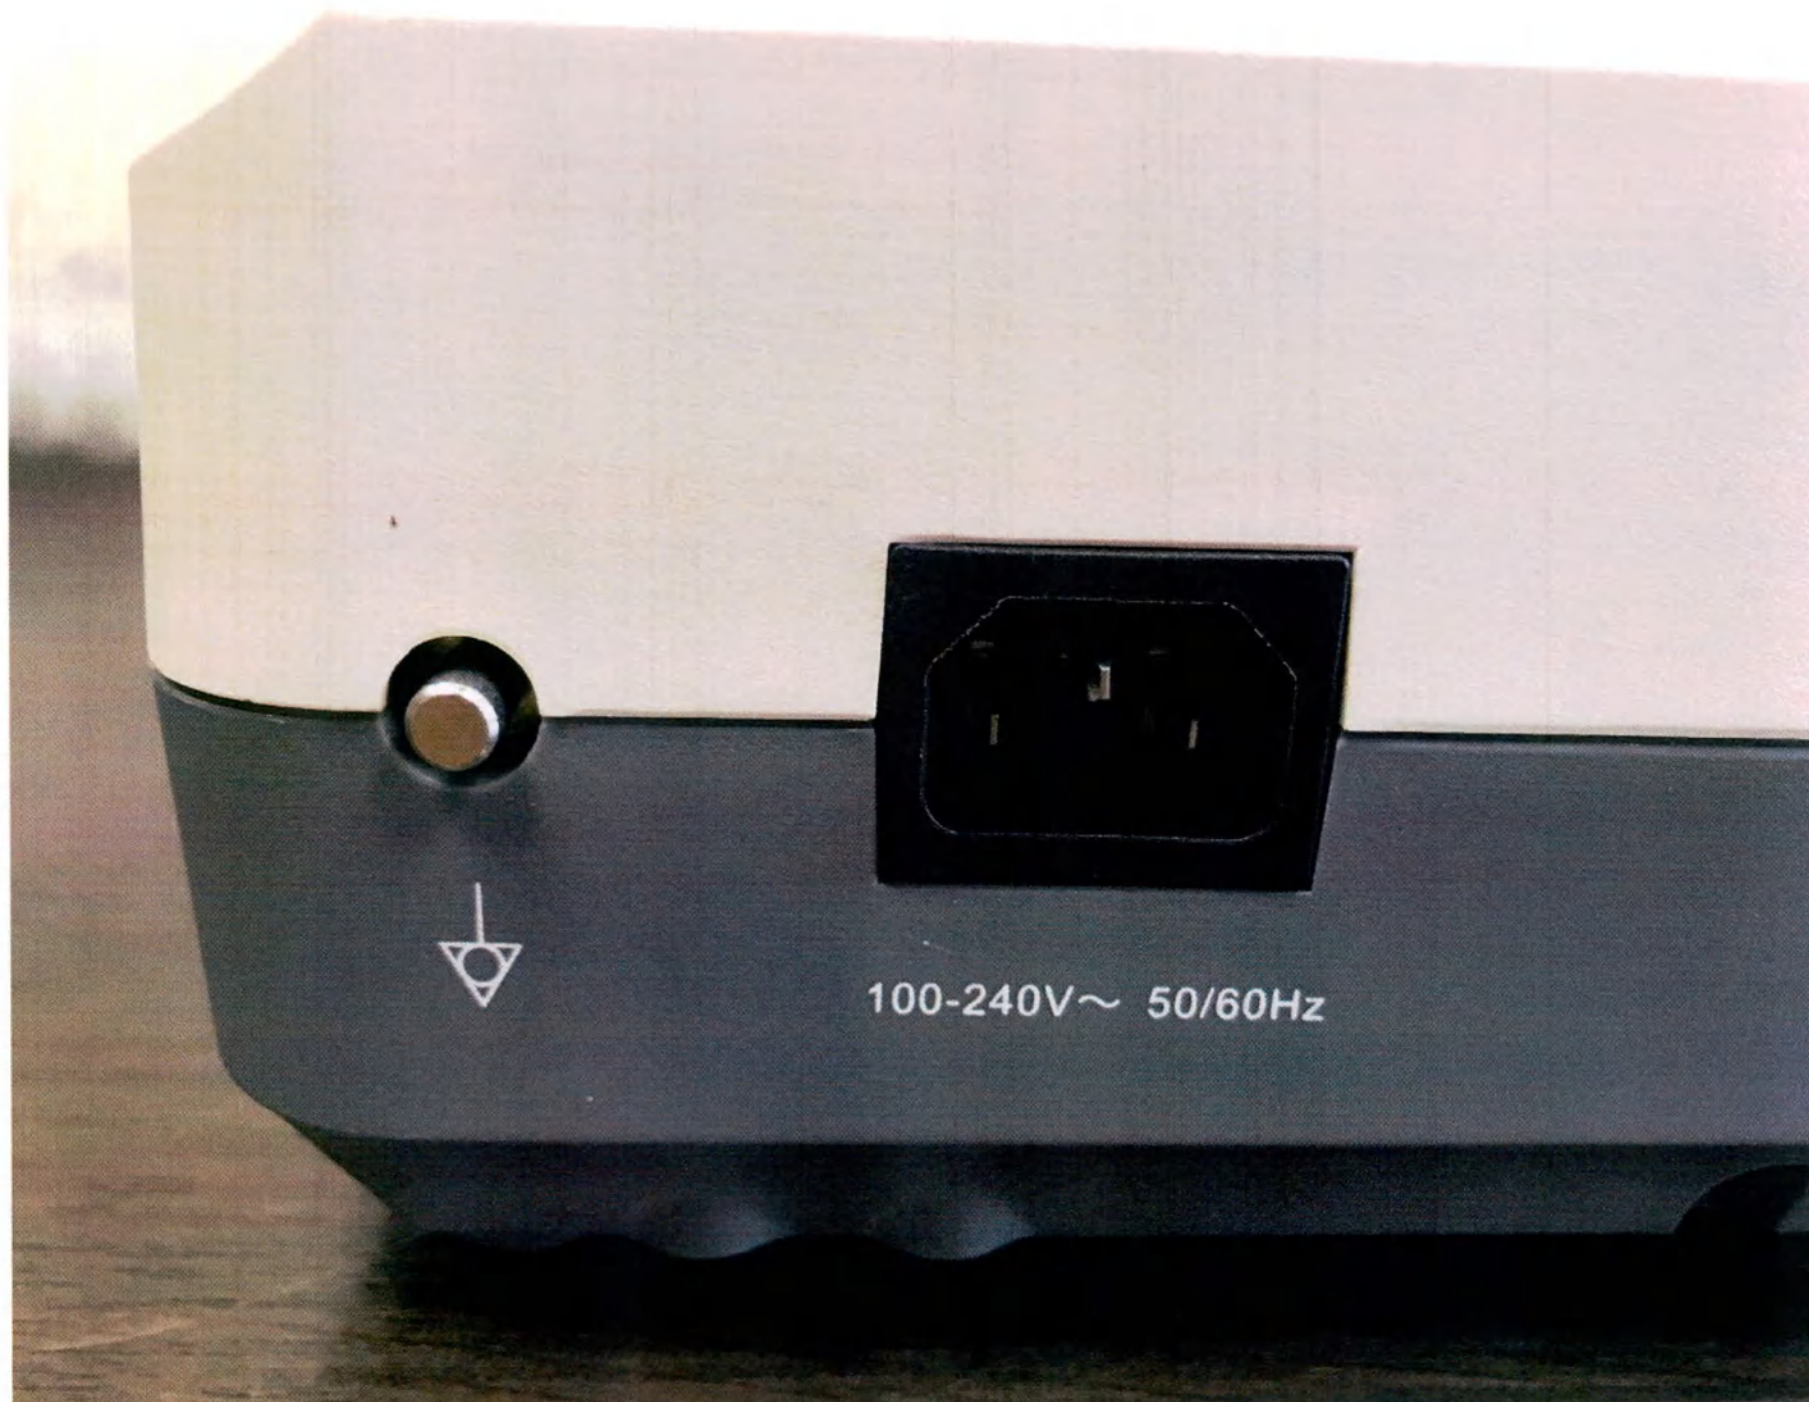

Блок базовый CM1200B (вид сверху, разъемы)



Блок базовый CM1200B (задняя панель)

SN 92220926005

 26.09.2022

COMEN




Электрокардиограф CM1200B

Номинальное напряжение: 100–240В~

Номинальная частота: 50/60Гц

Номинальная мощность: 95ВА



IPX0

Регистрационное удостоверение
№ РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)


Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ. 6Н С НОМ 39.49

Блок базовый CM1200B (маркировка)

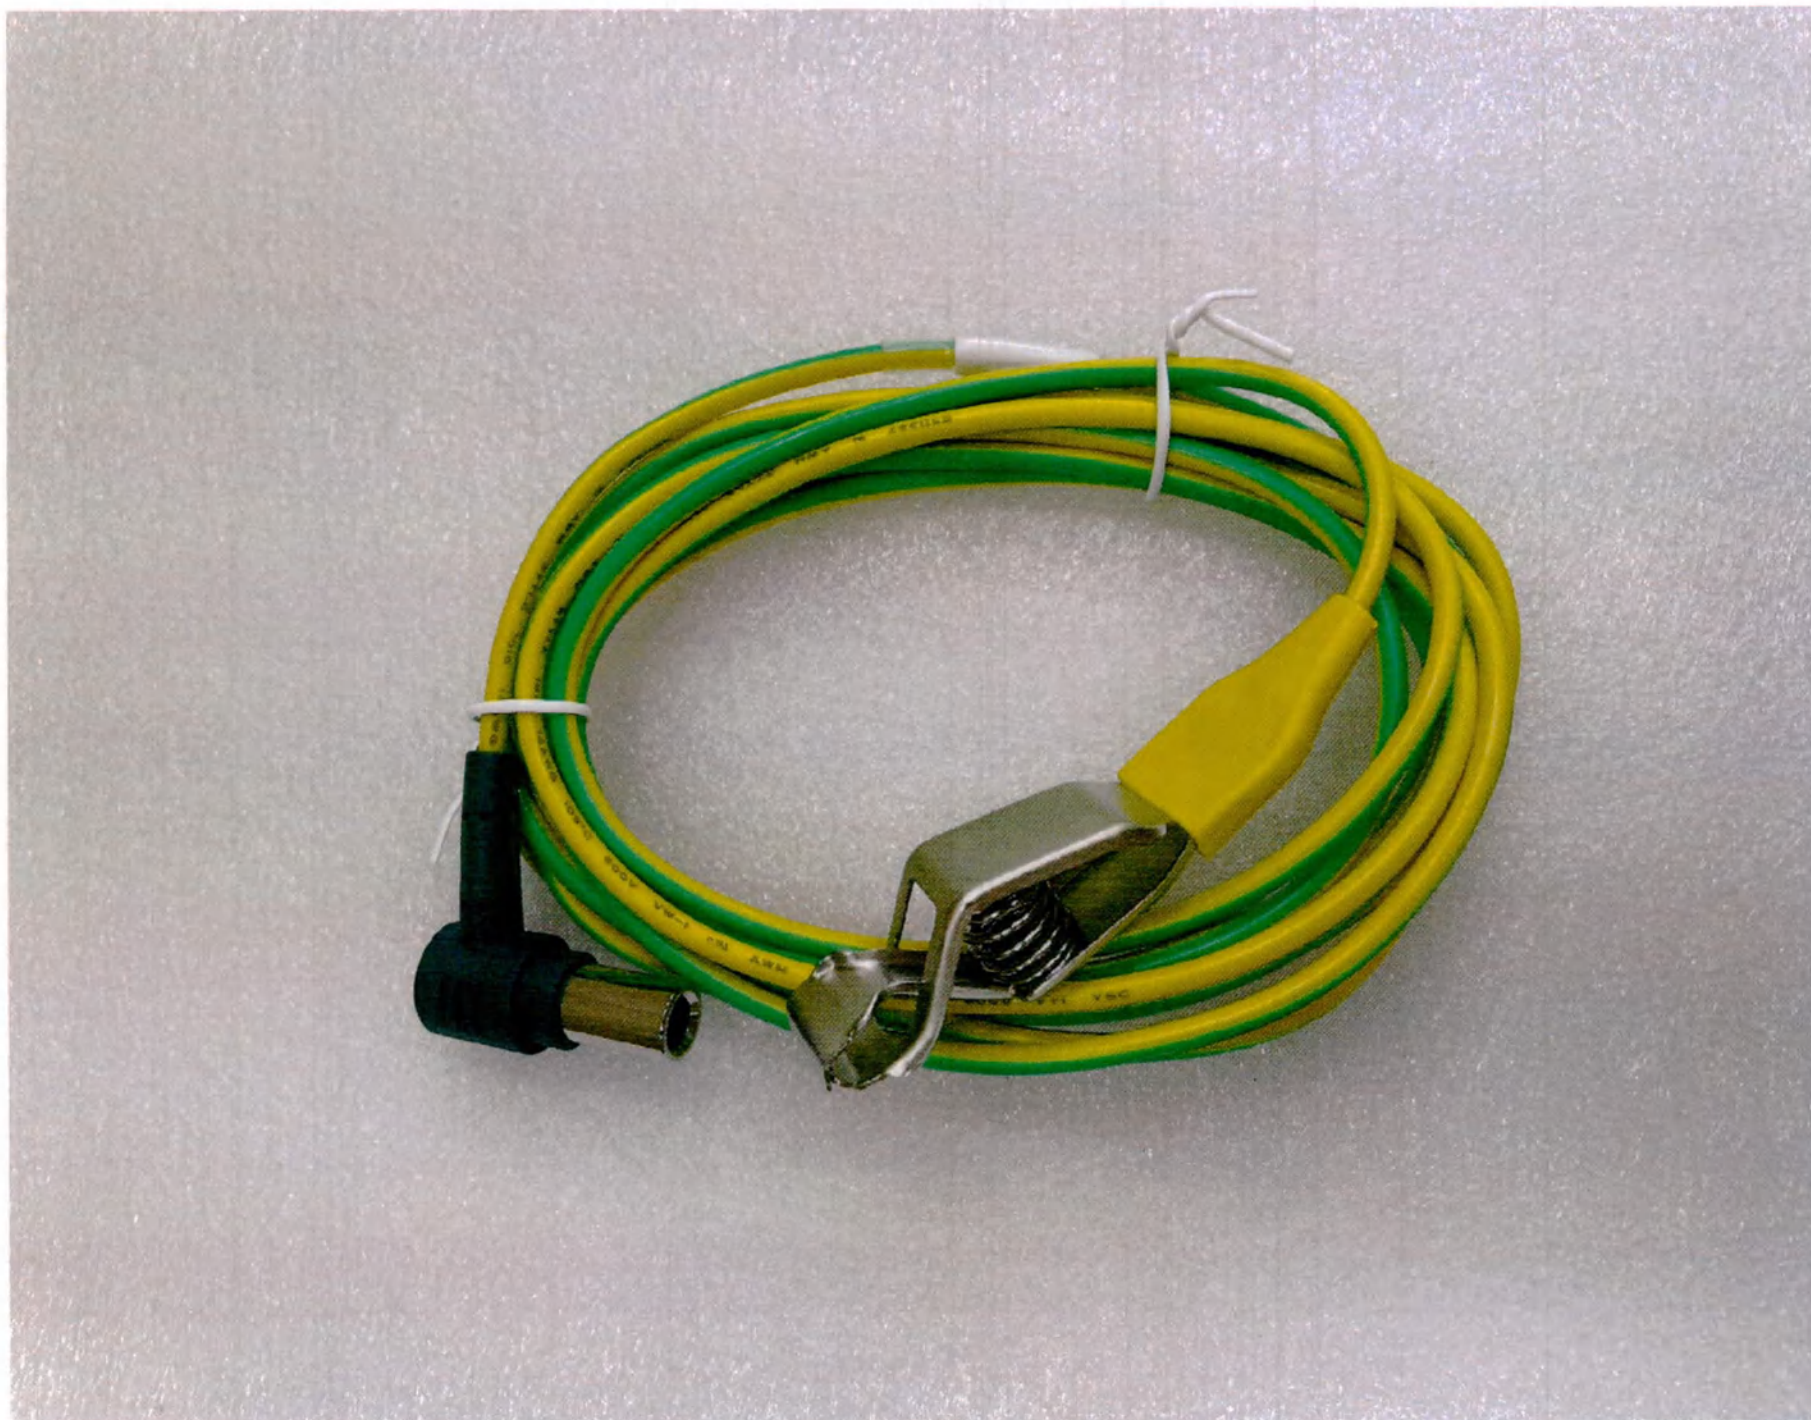

Кабель заземления



Кабель питания

Revision 1 / Редакция 1

	«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ» Director General / Генеральный директор Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./ Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд. _____ Yi Yong (И Юн) « 02 » 05 2023 г. Stamp/печать
--	--

USER MANUAL OF MEDICAL DEVICE/
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Electrocardiograph, in versions/
Электрокардиограф, в вариантах исполнения**

**Electrocardiograph CM1200B/
Электрокардиограф CM1200B**

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./
Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.



Кабель ЭКГ на 12 отведений: Пример индивидуальной упаковки

SN**20230303 0031****COMEN****03.03.2023****Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1**

Количество в упаковке – 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.


(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China


Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.


Регистрационное удостоверение №

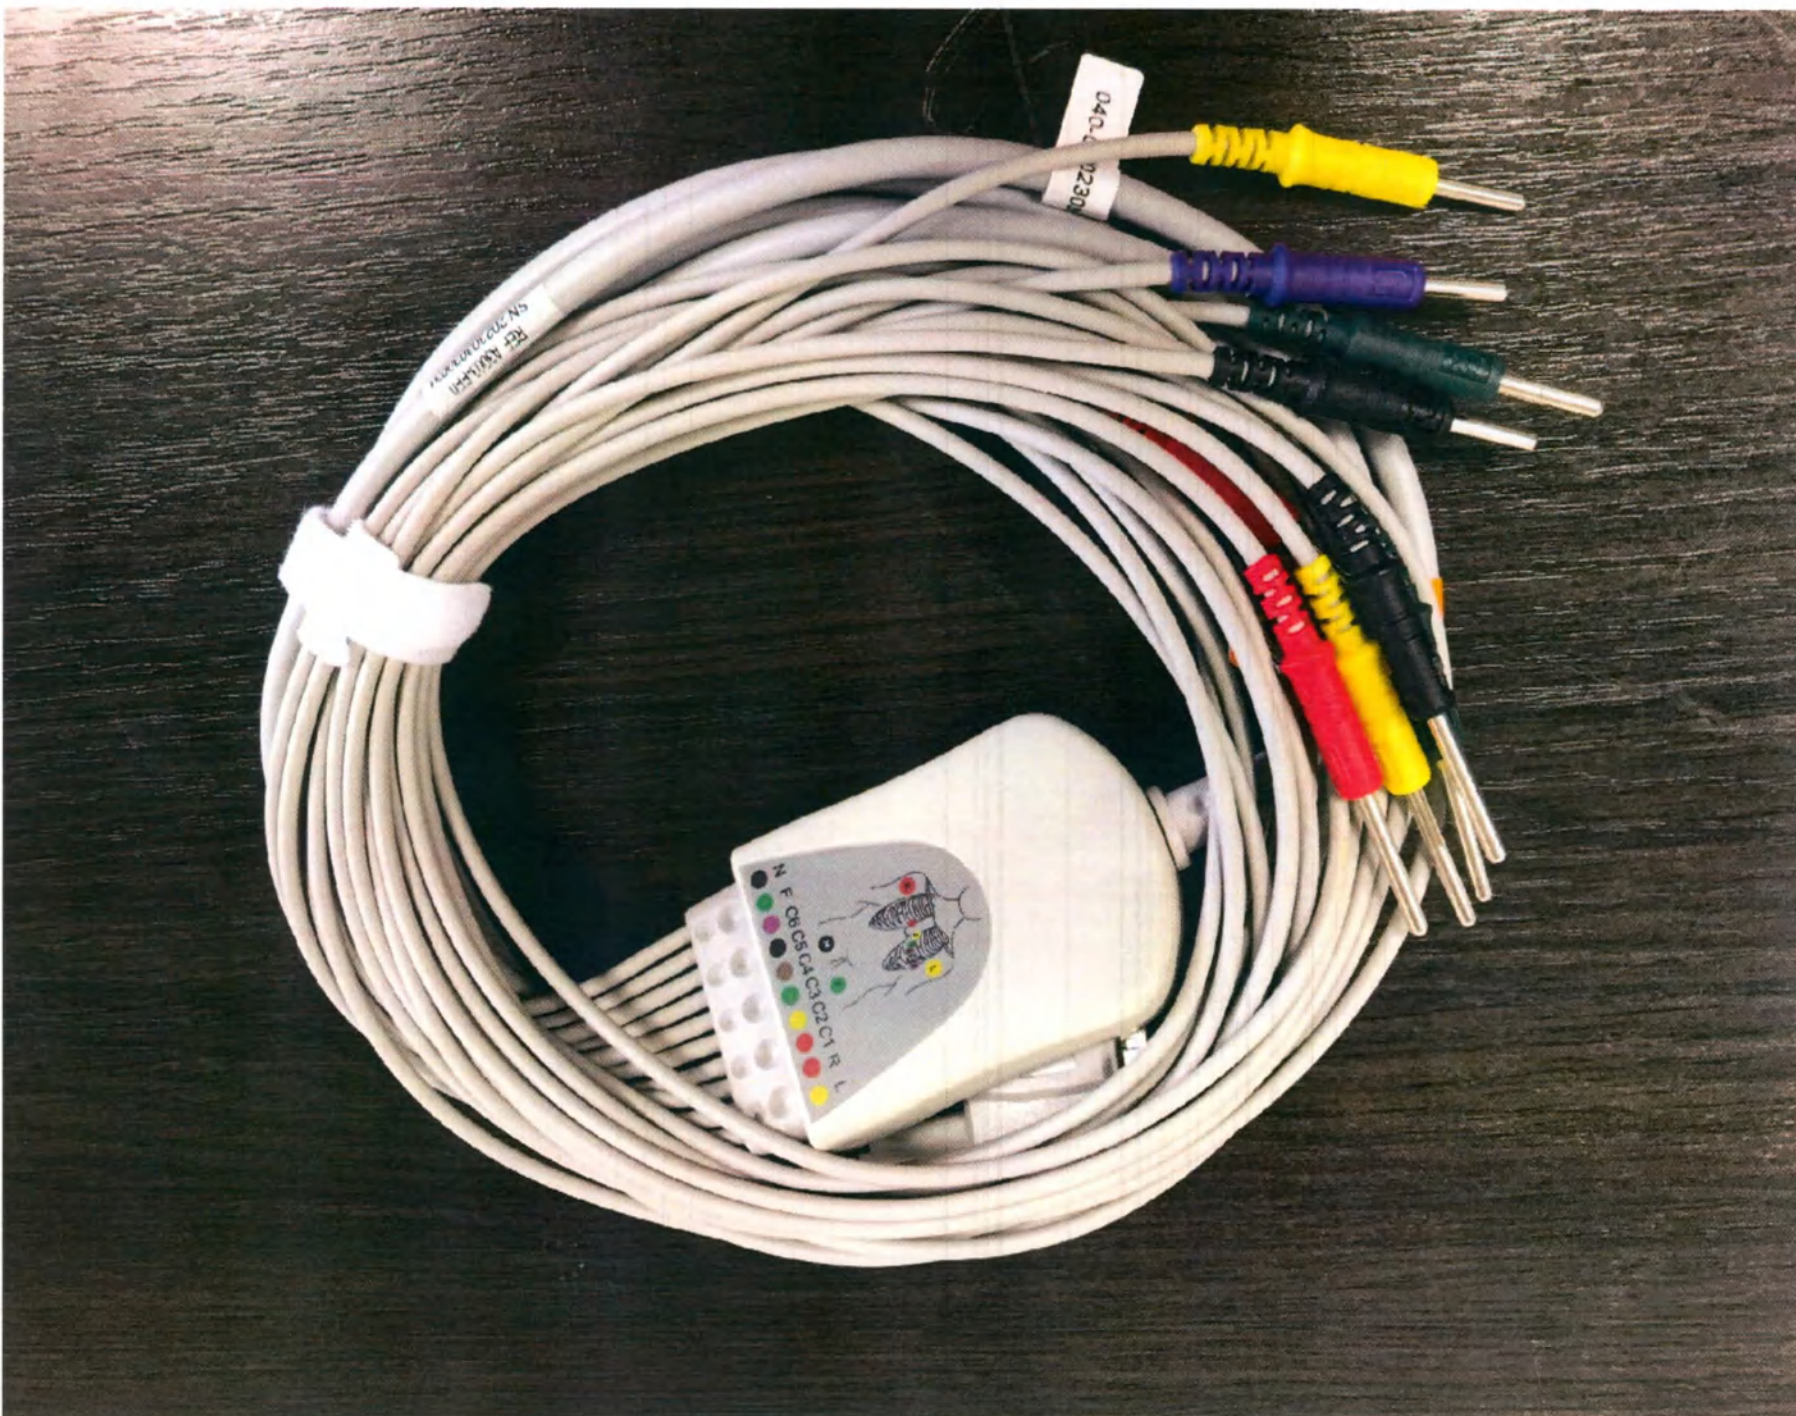


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (общий вид)

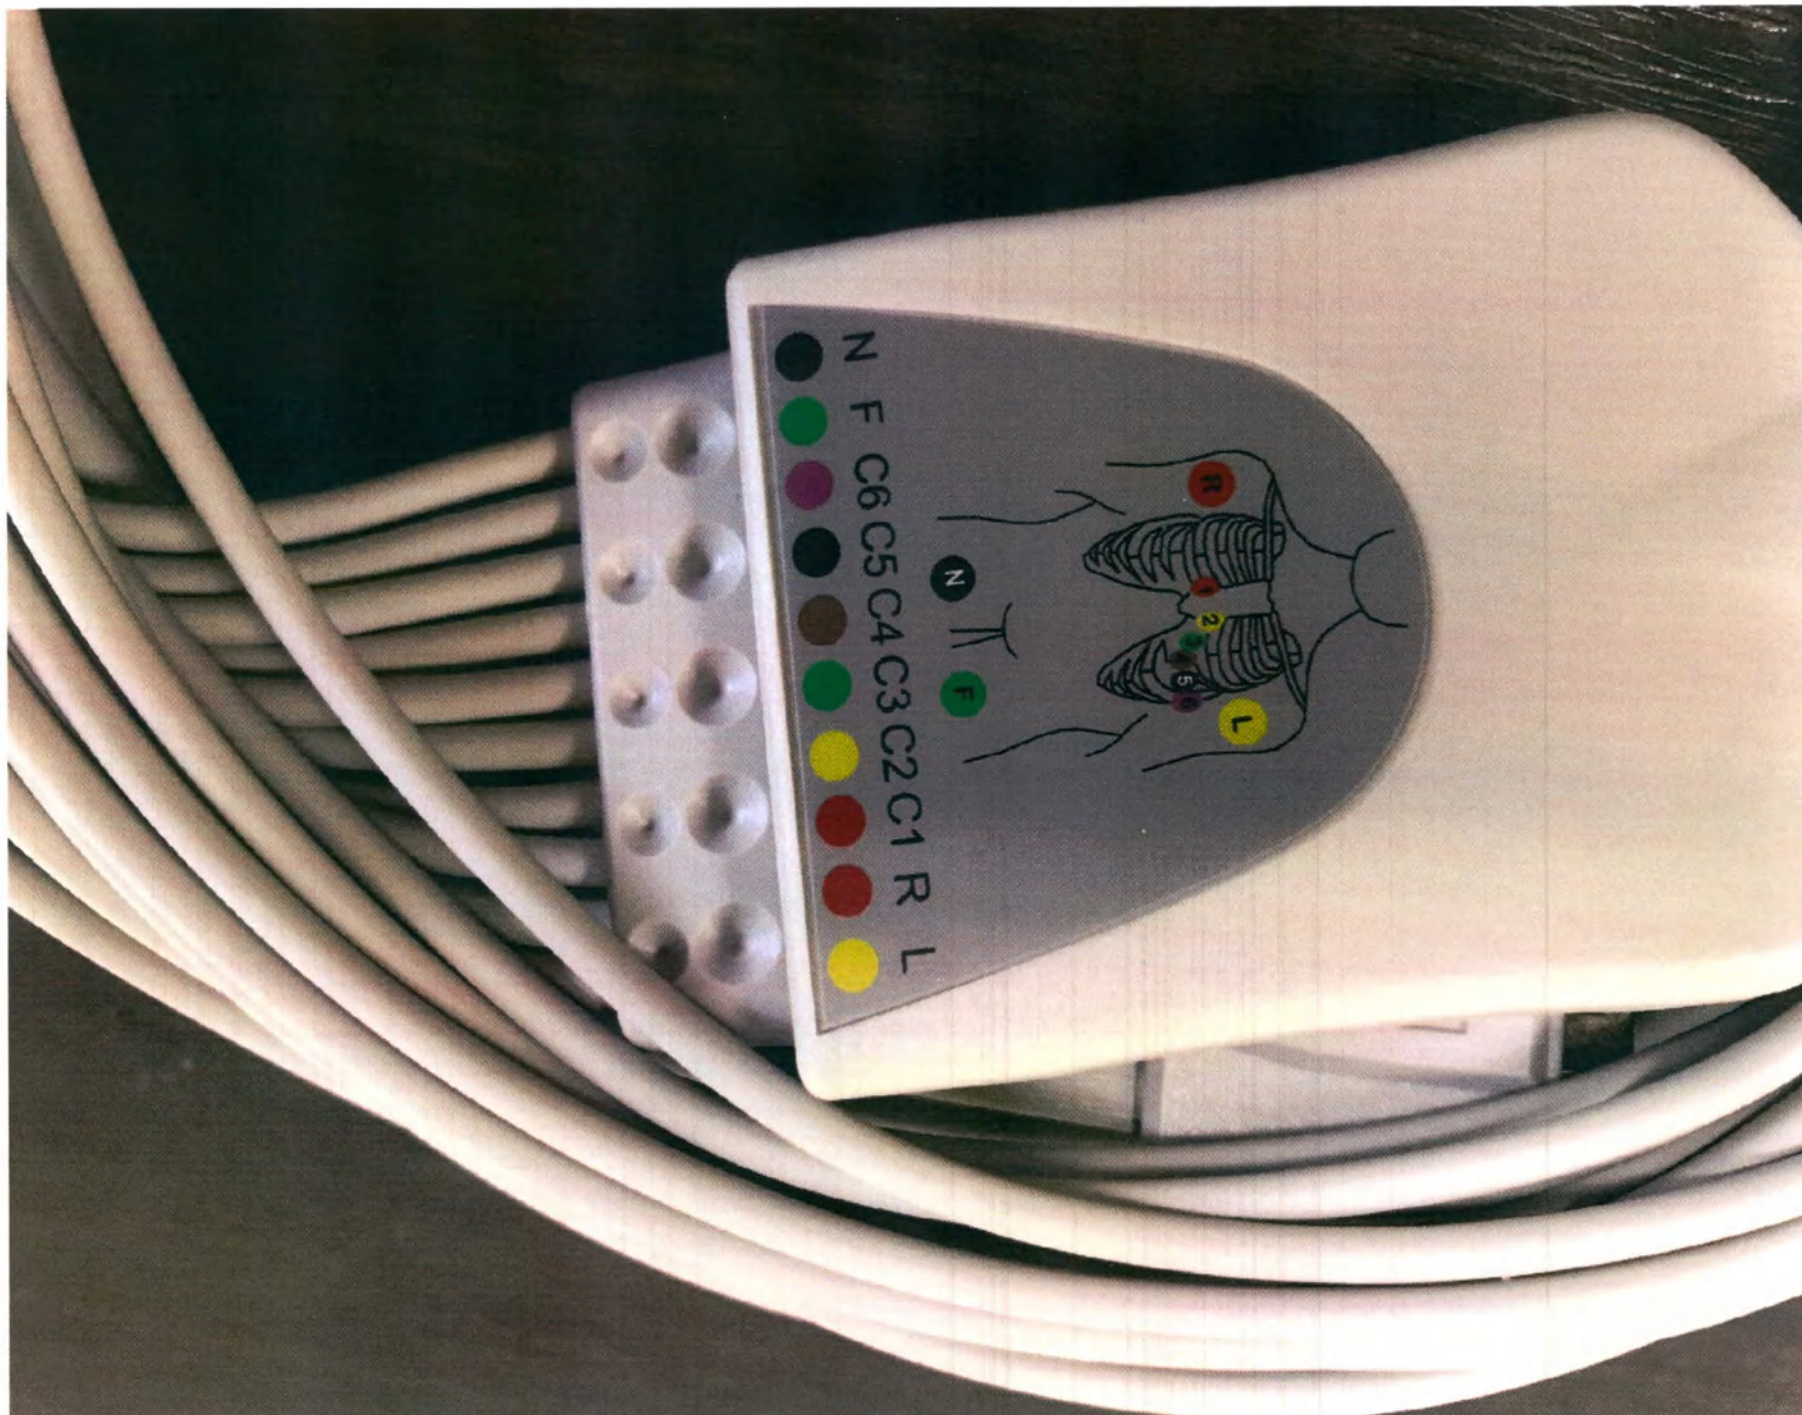


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (разъем отведений)

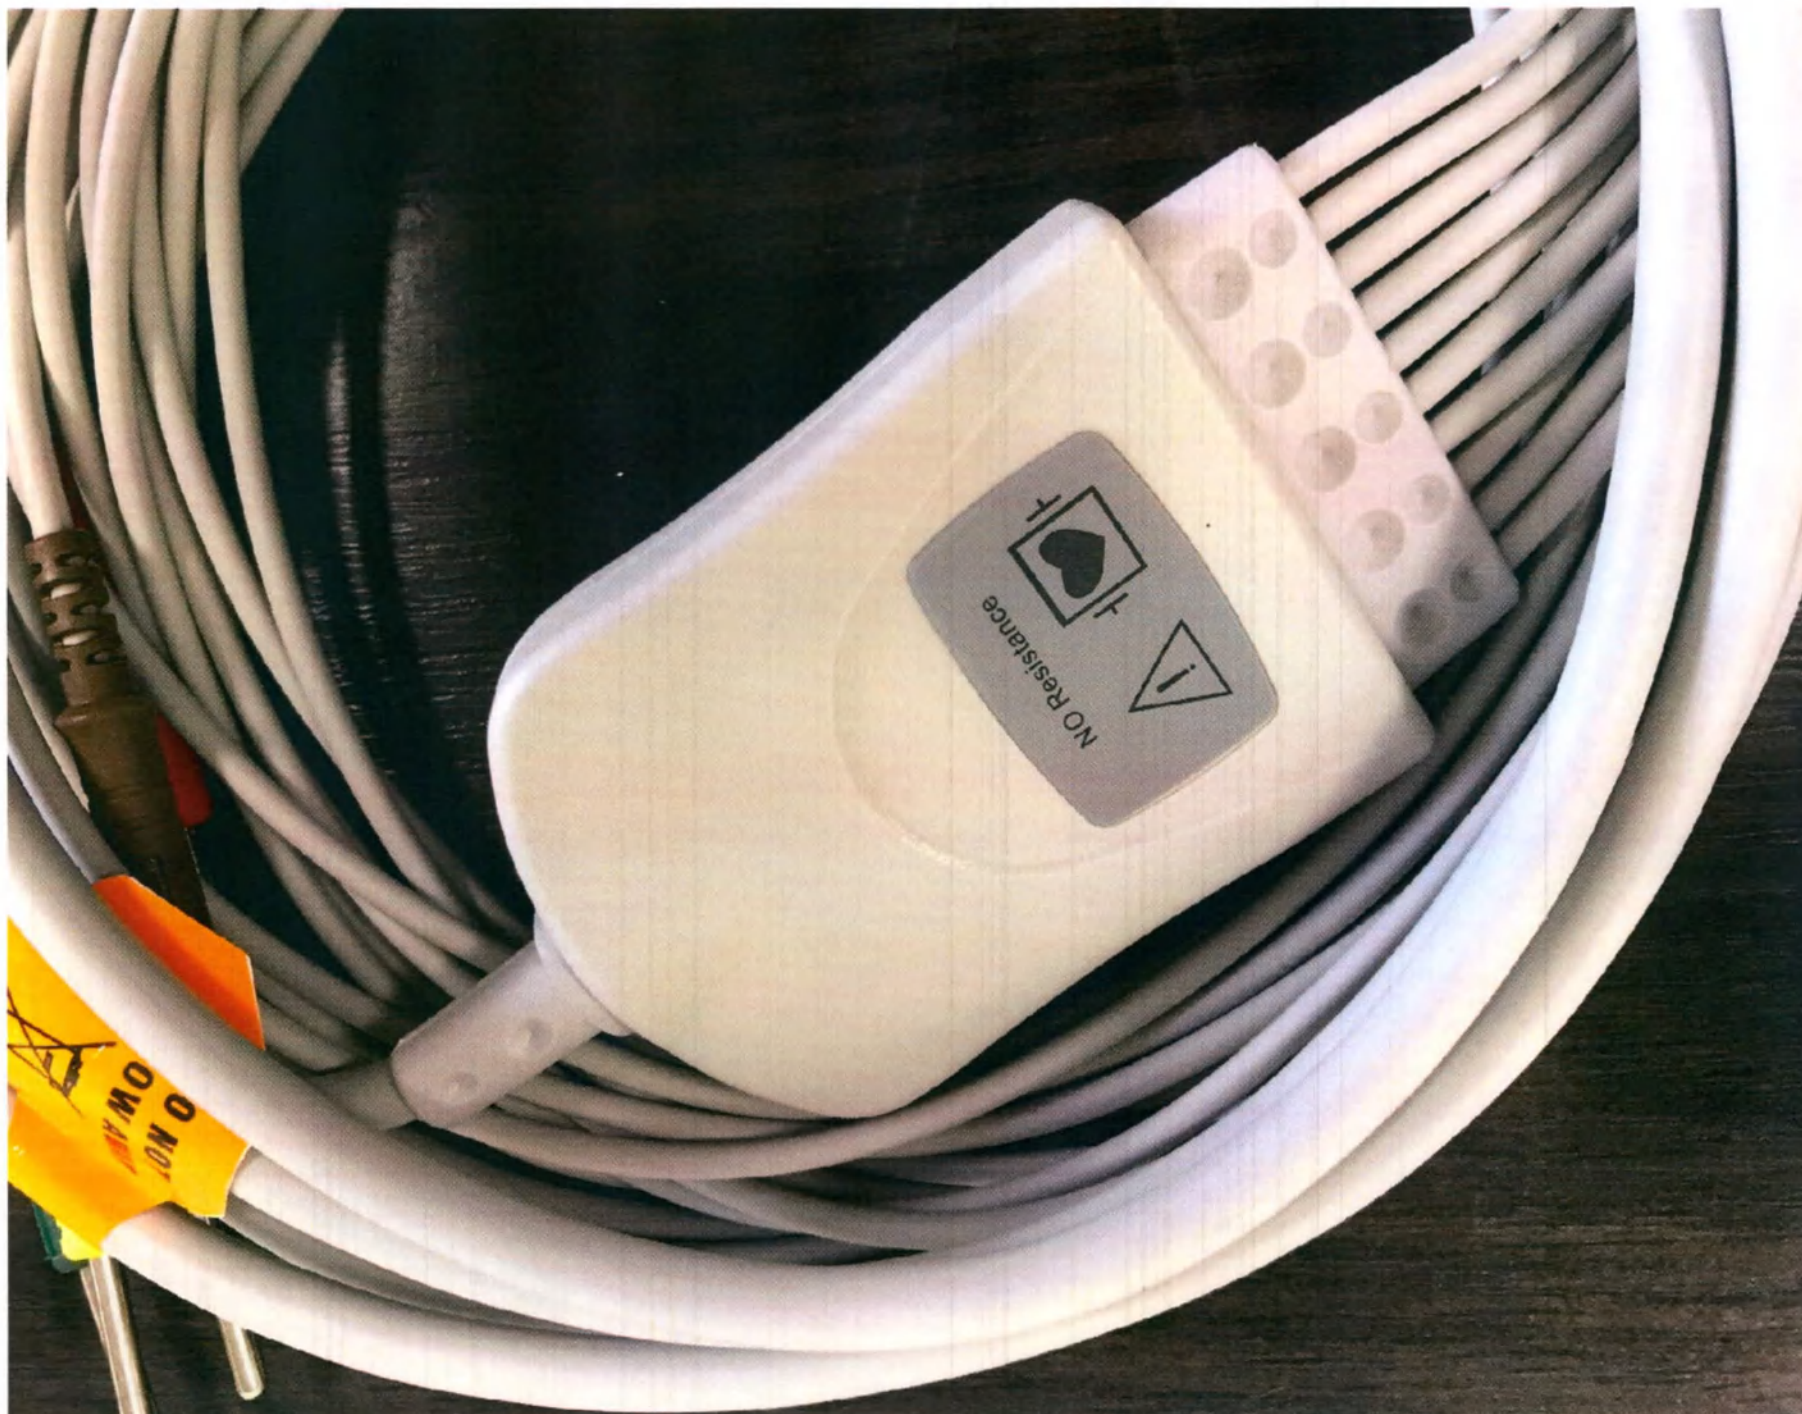


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (маркировка разъема отведений)

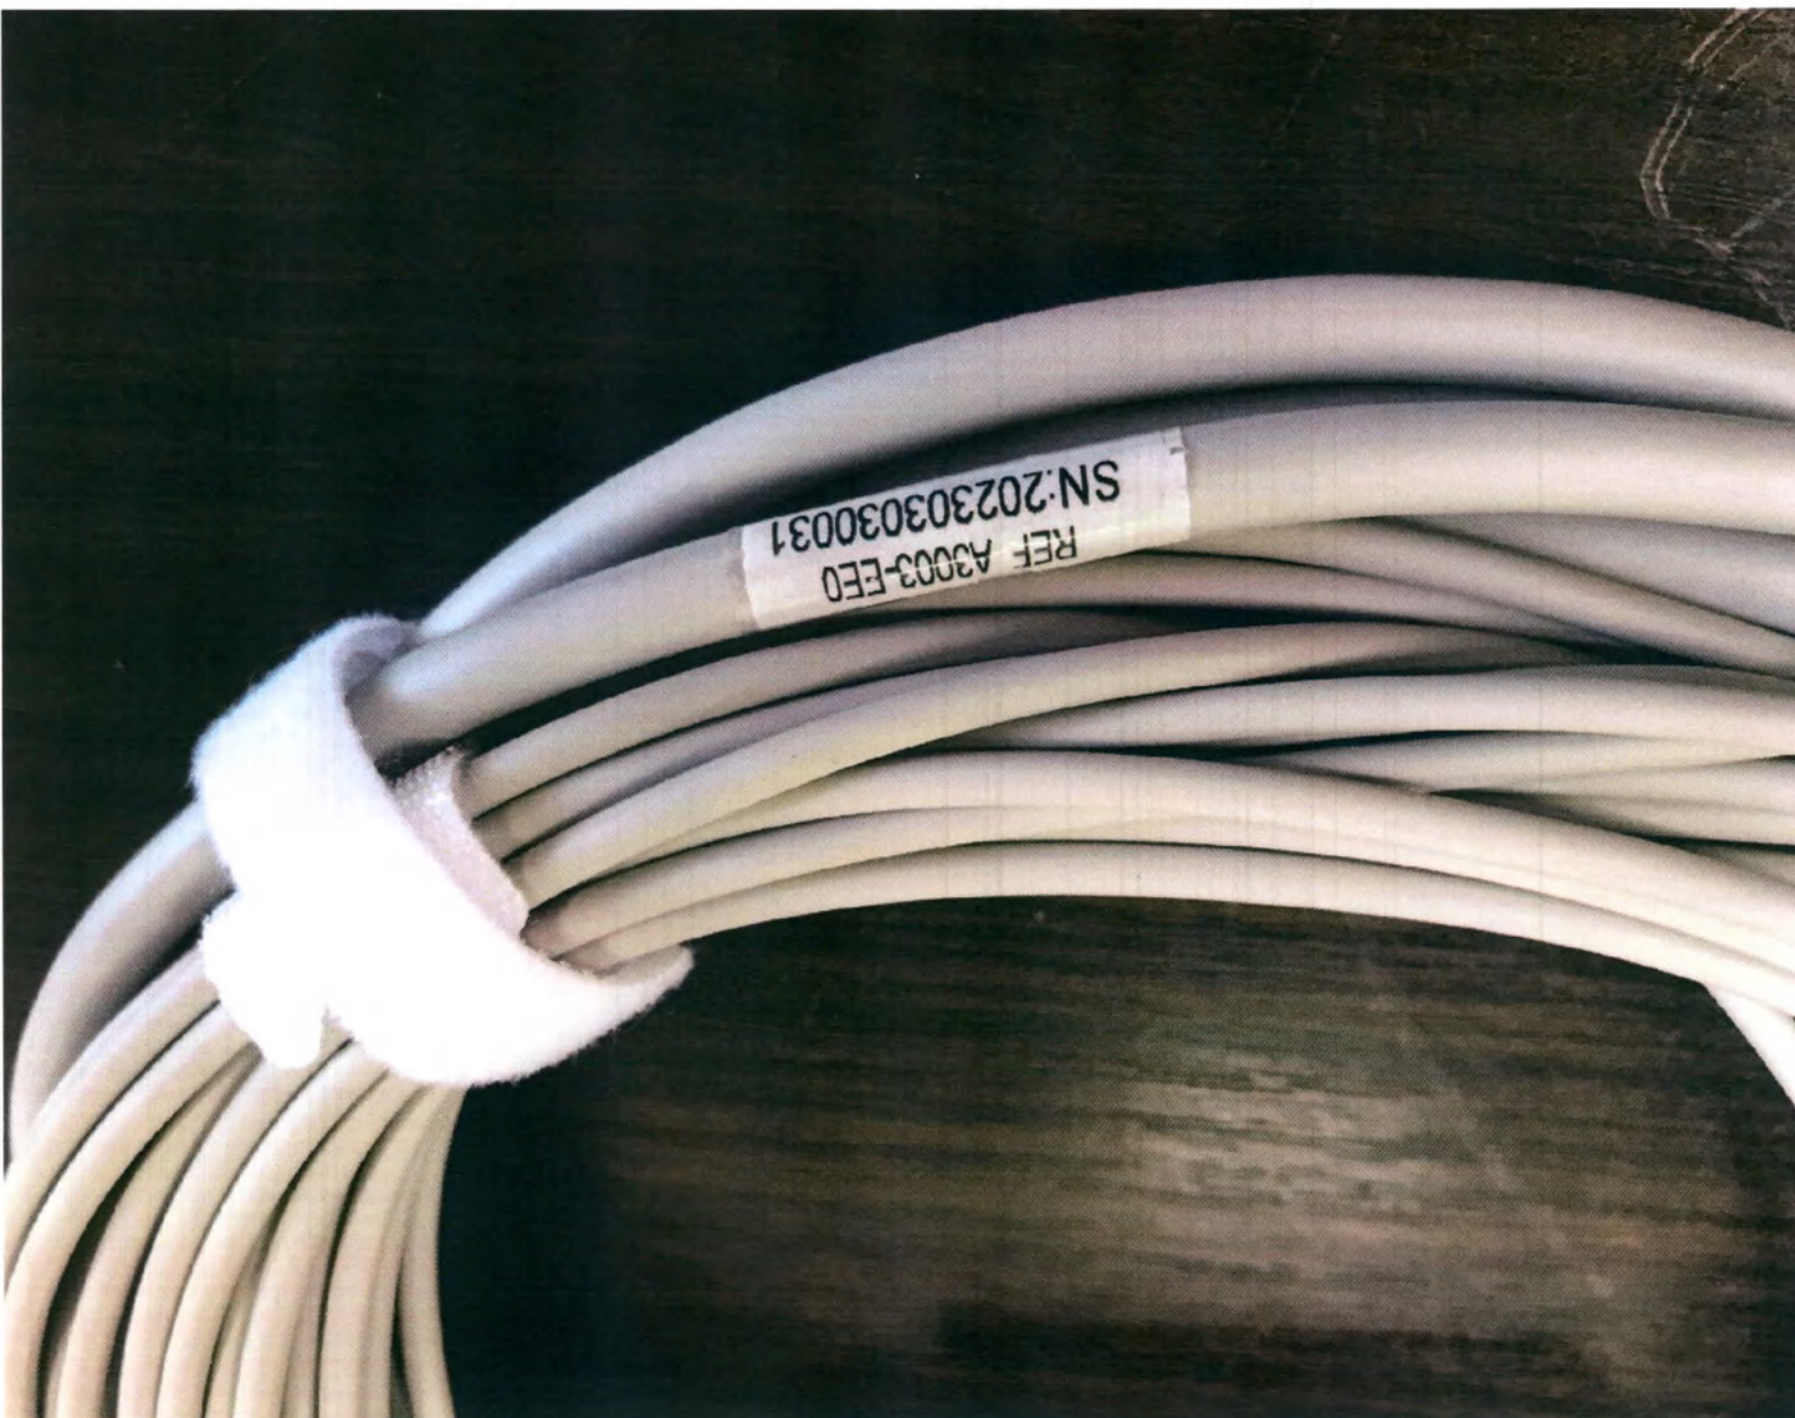

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (наклейка с серийным номером)

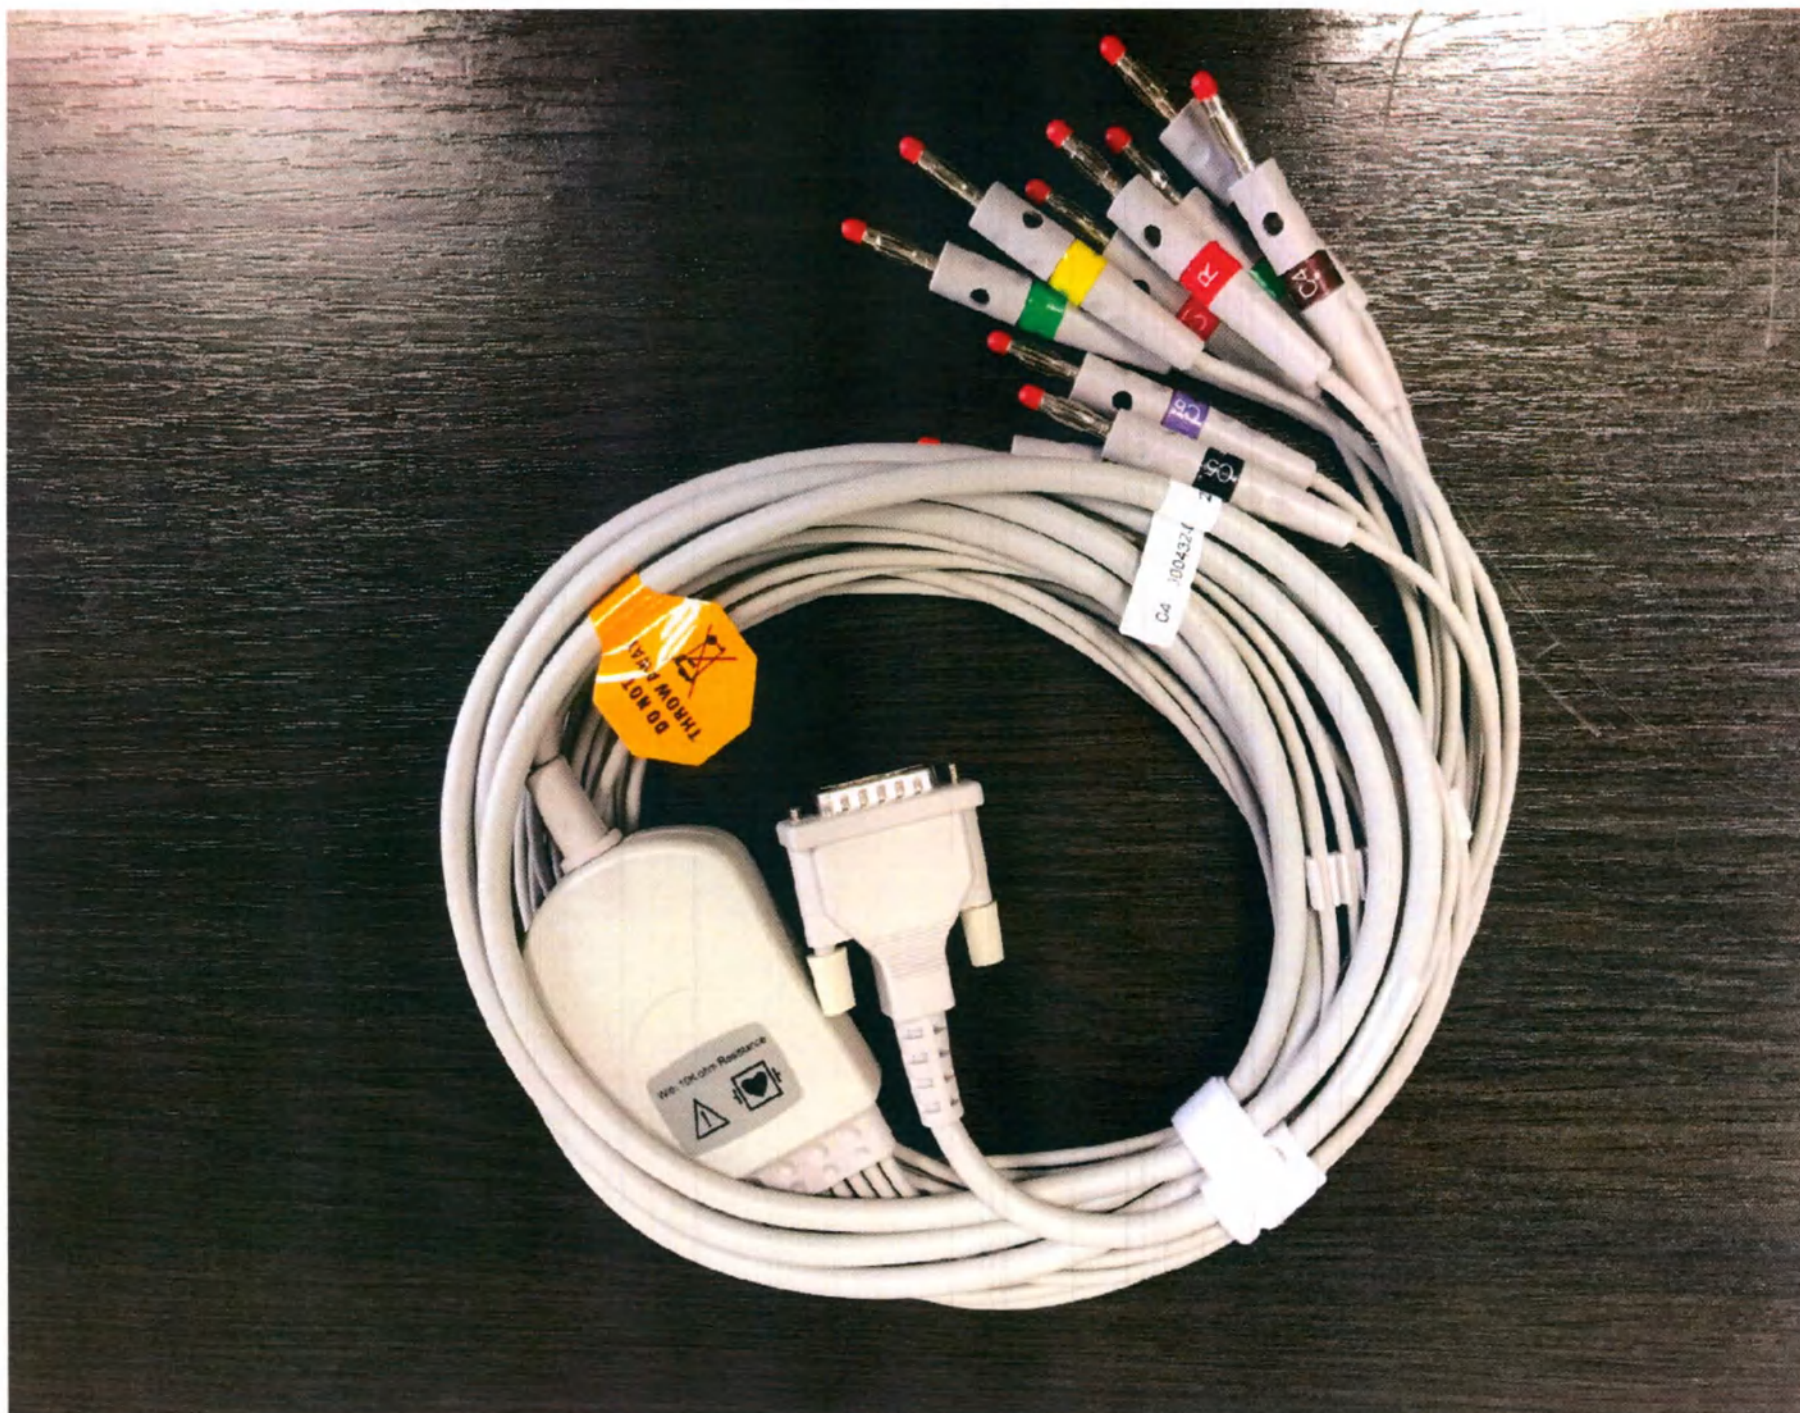

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (общий вид)

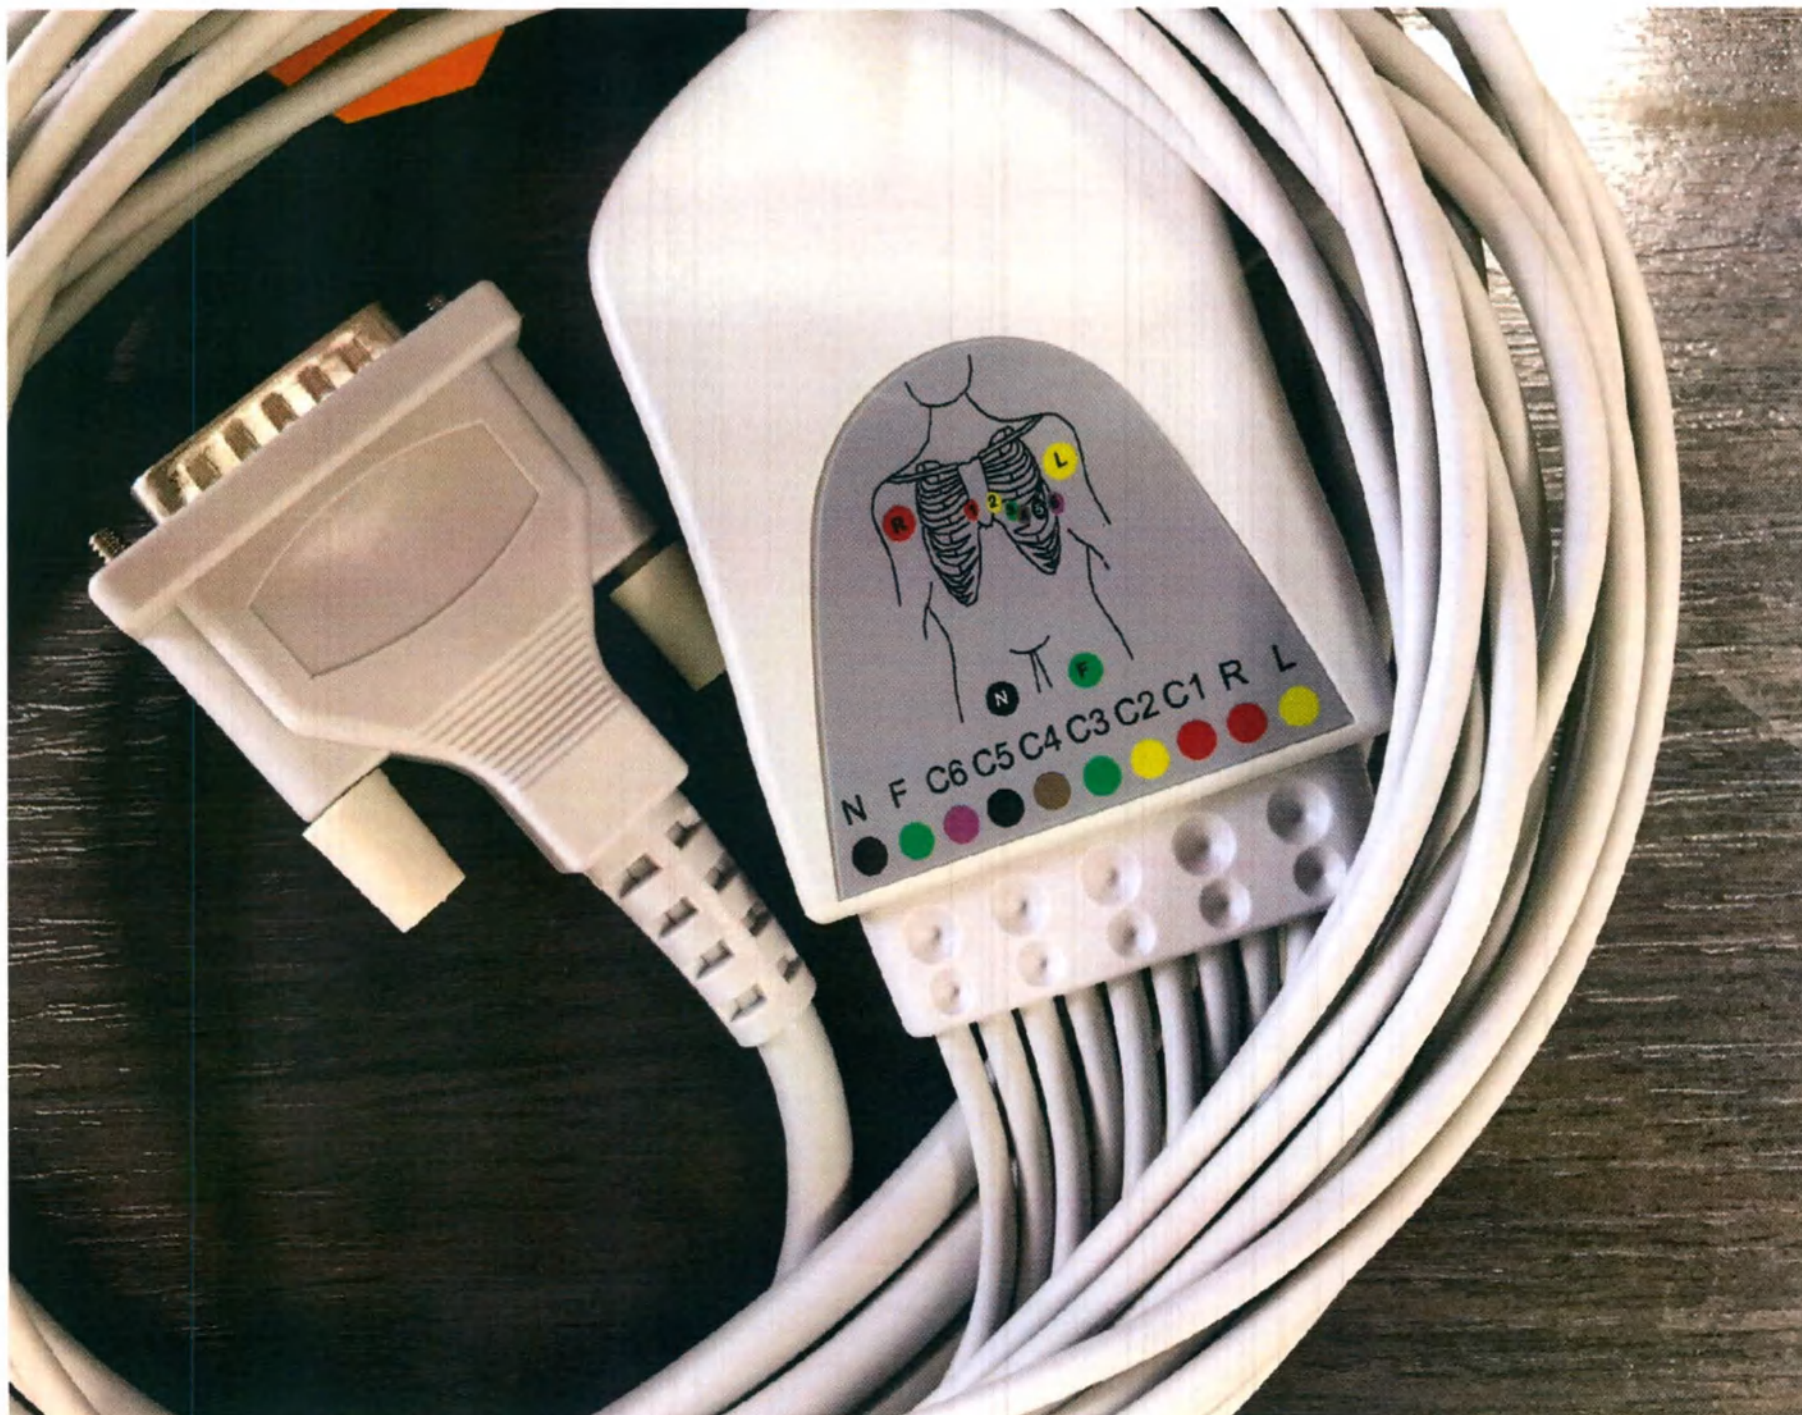


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений, маркировка)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (наклейка с серийным номером)

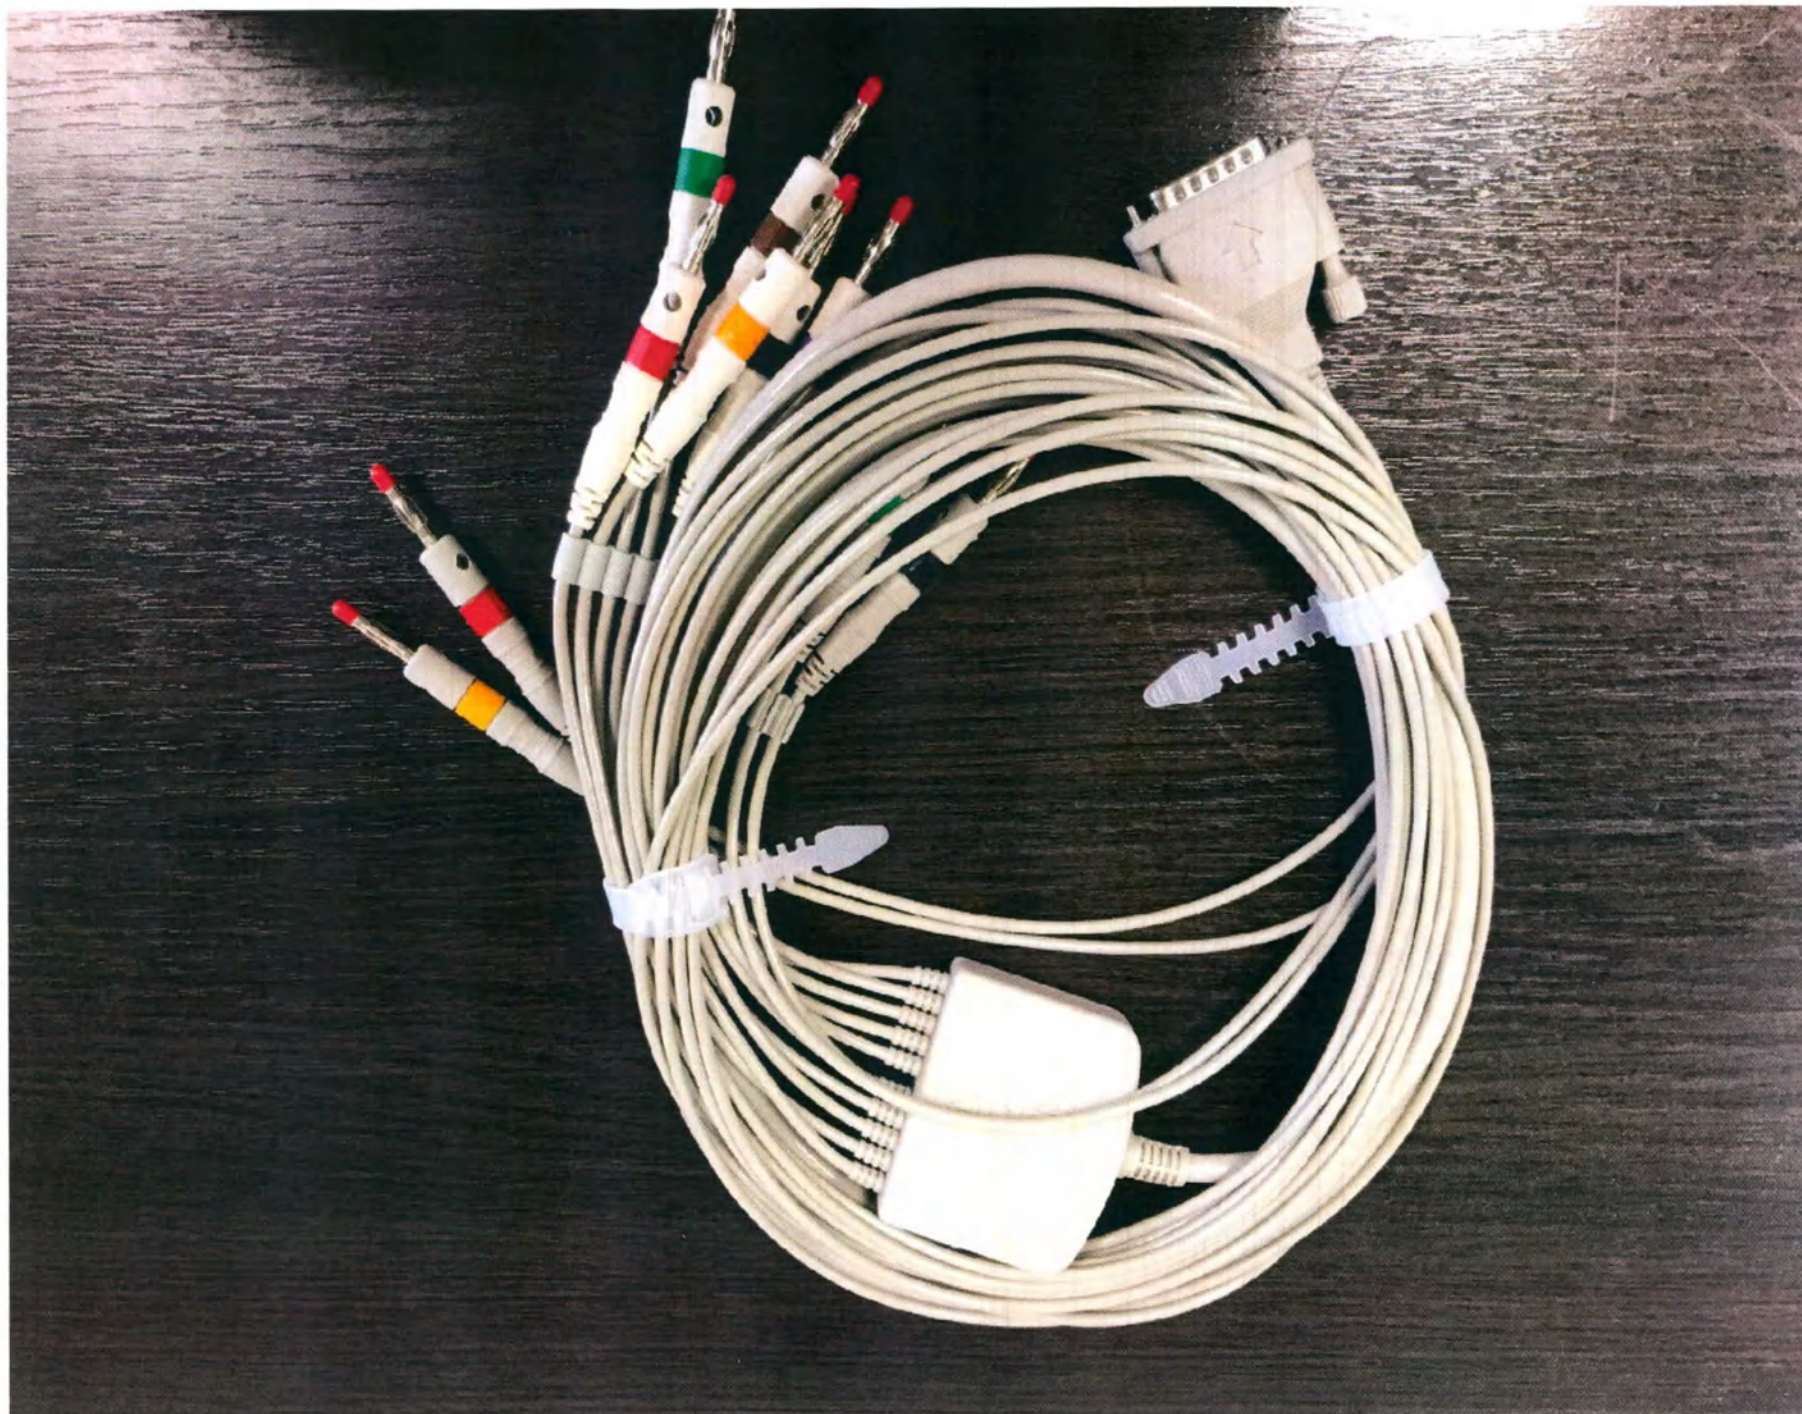

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (общий вид))

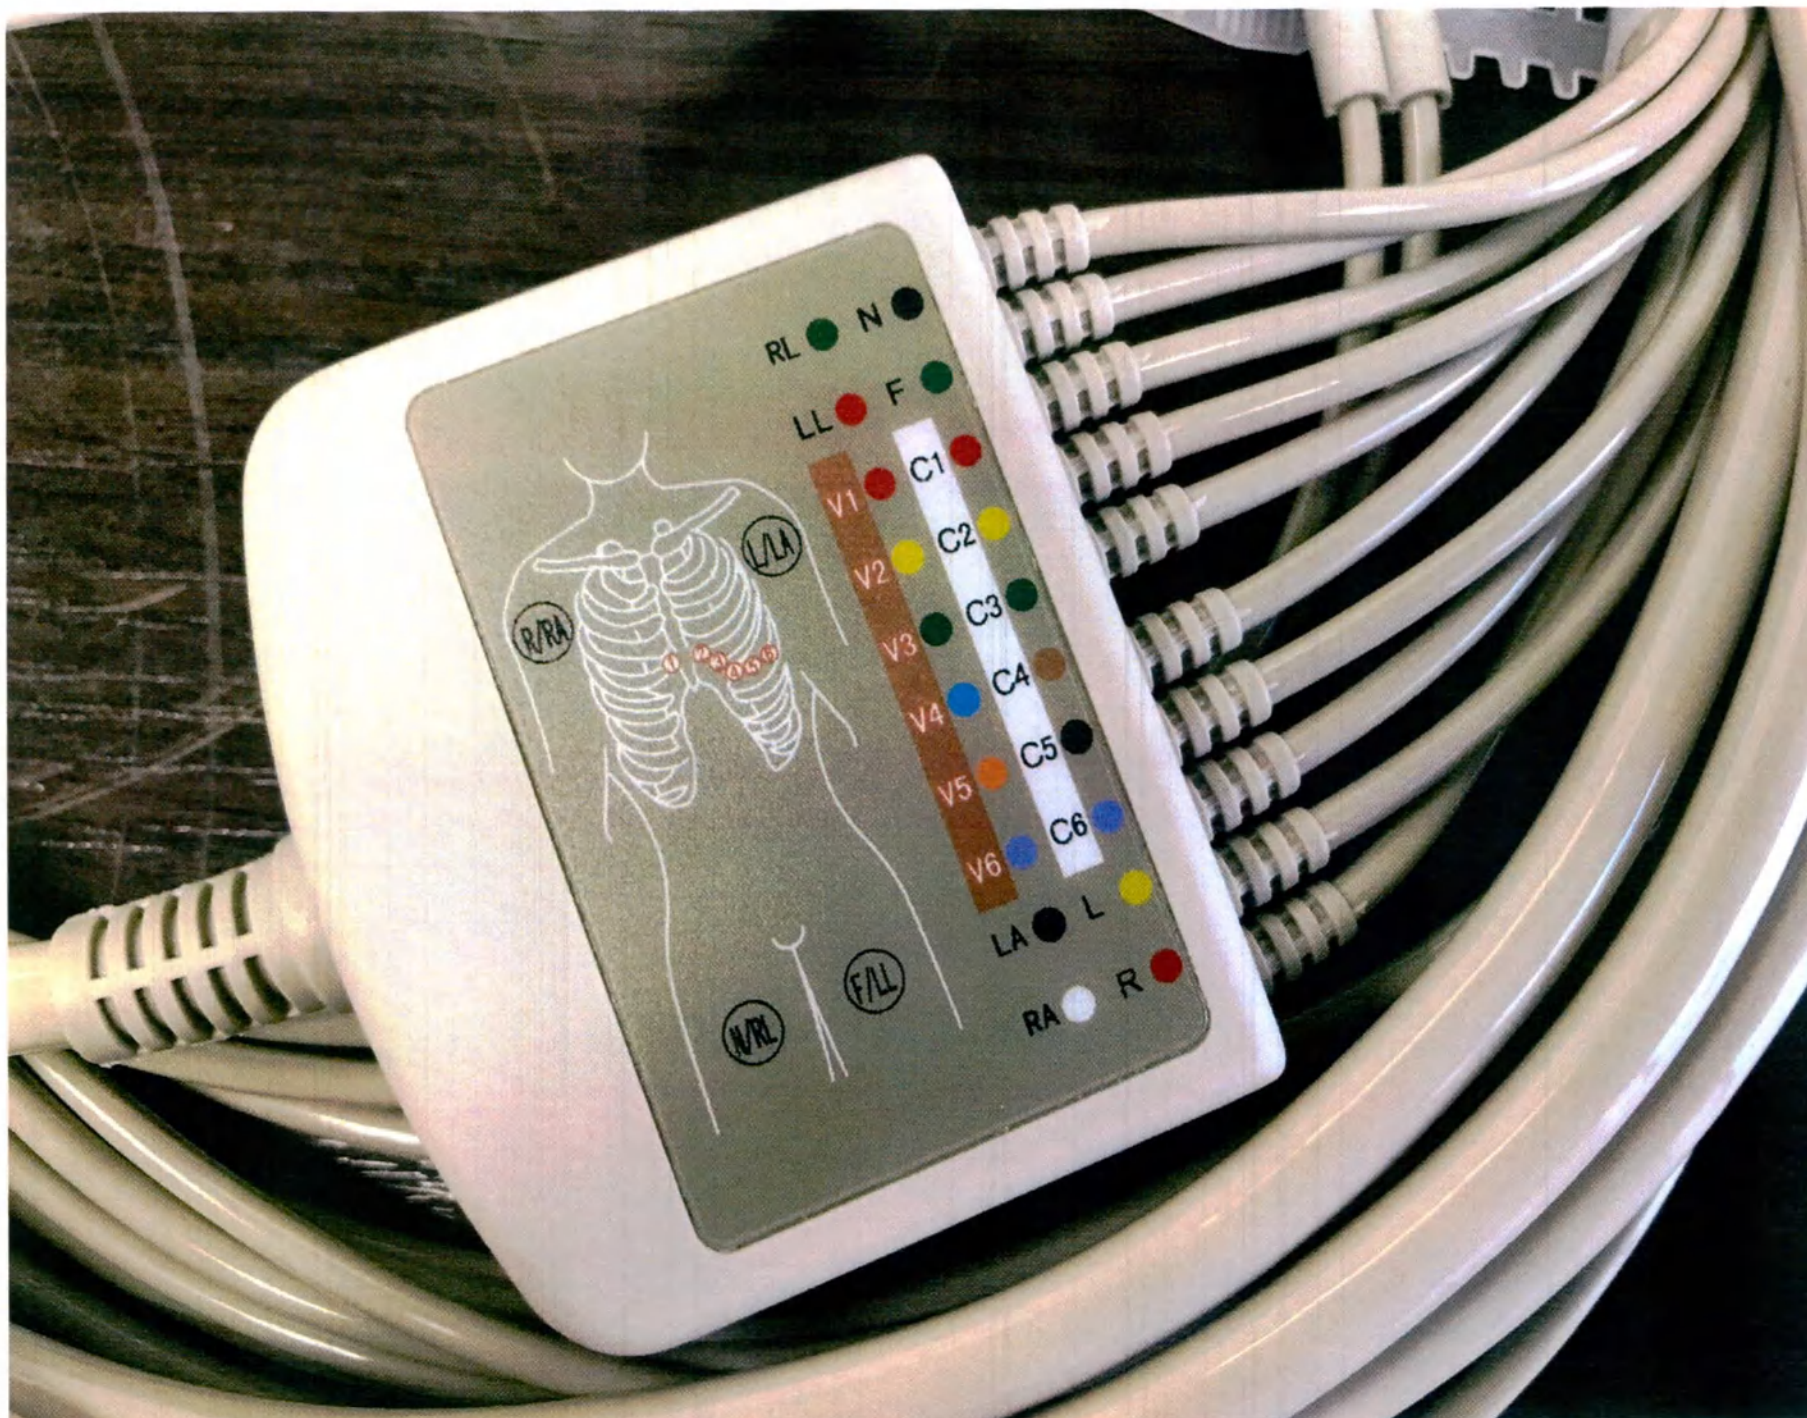


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (разъем отведений)

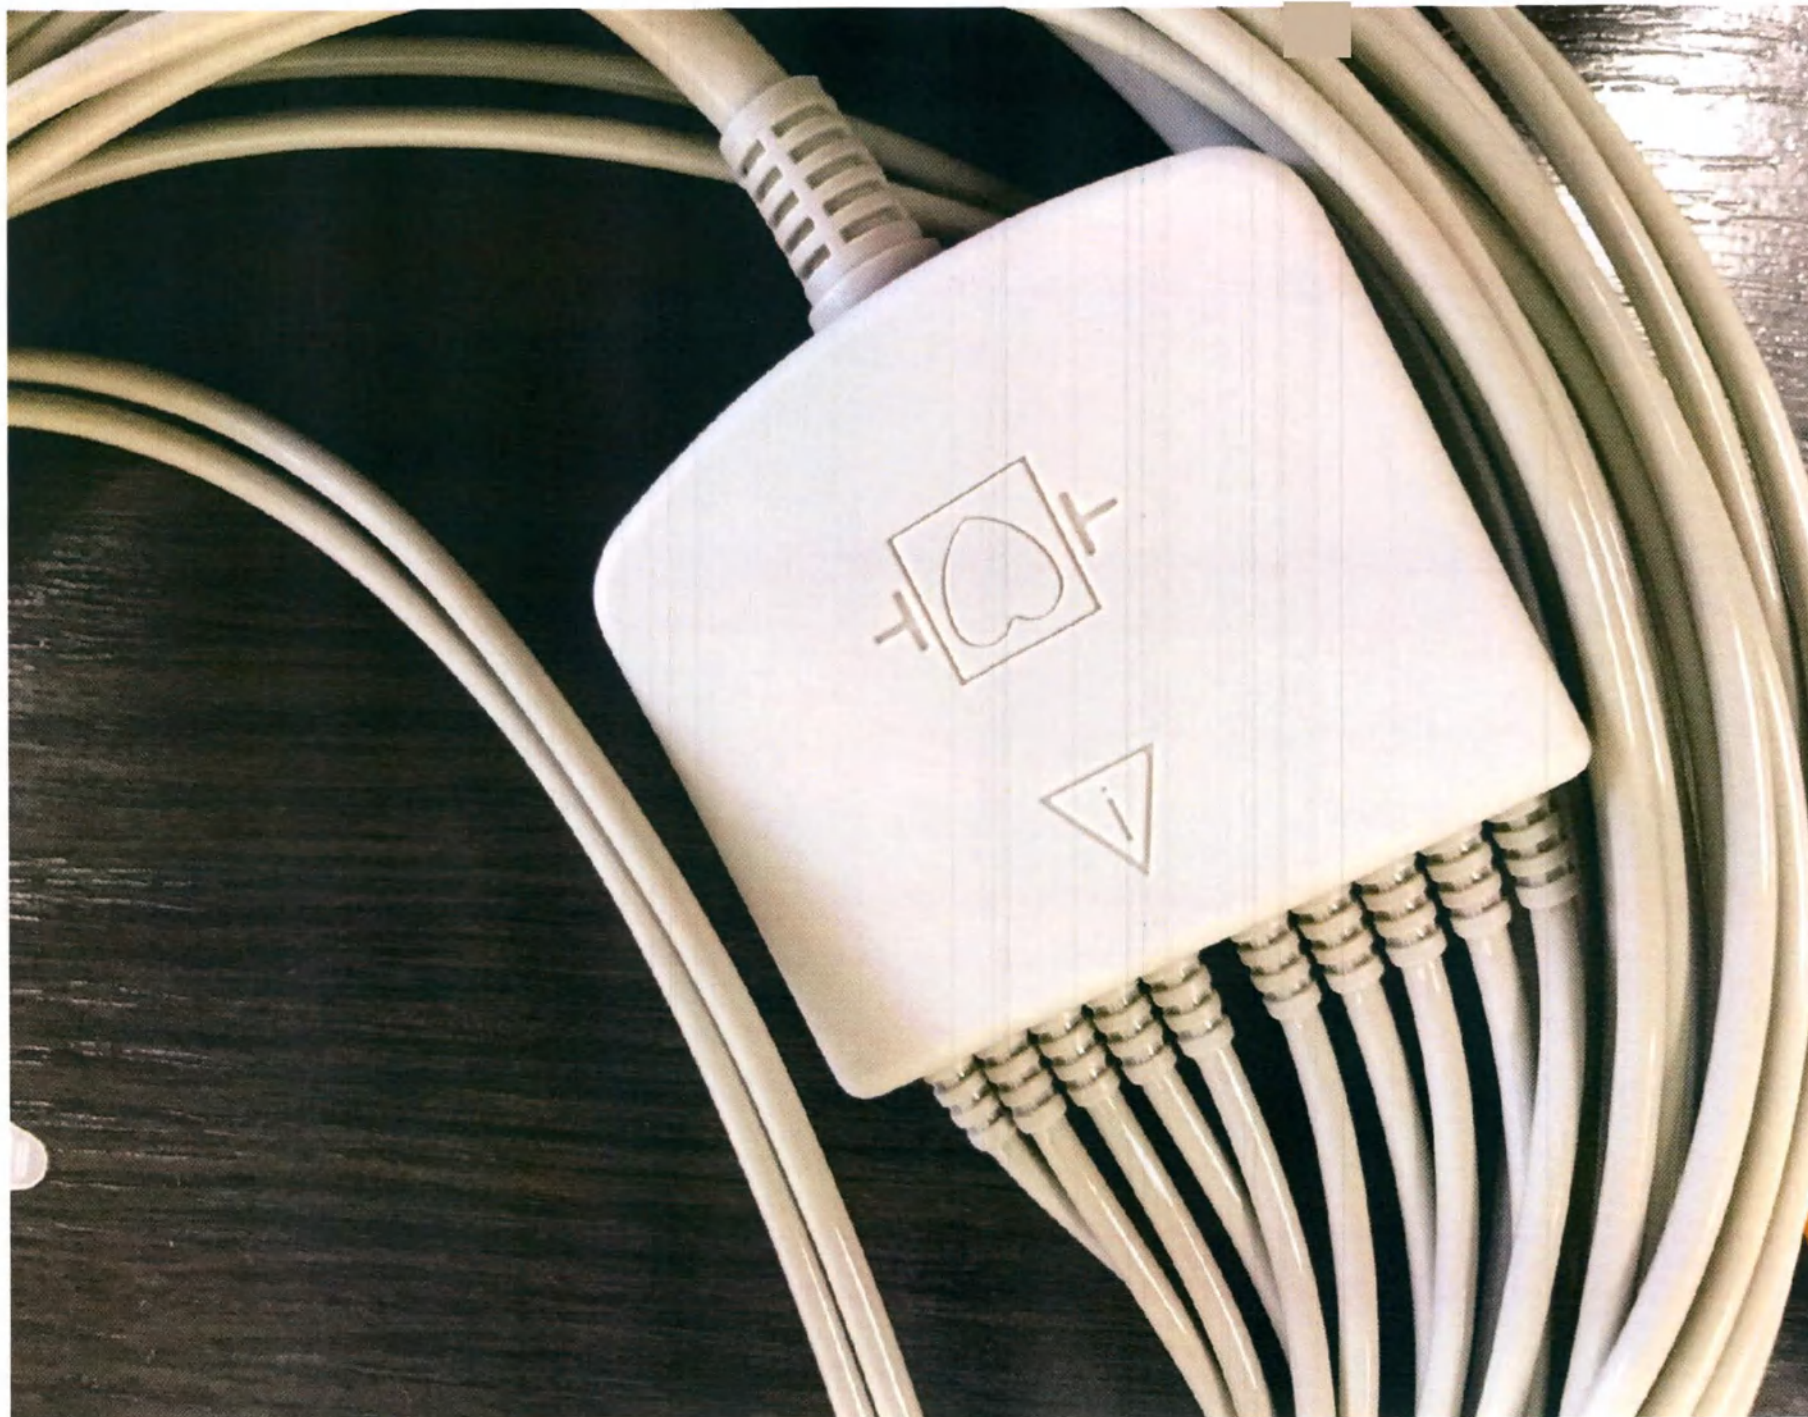

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (маркировка разъема отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (наклейка с серийным номером)

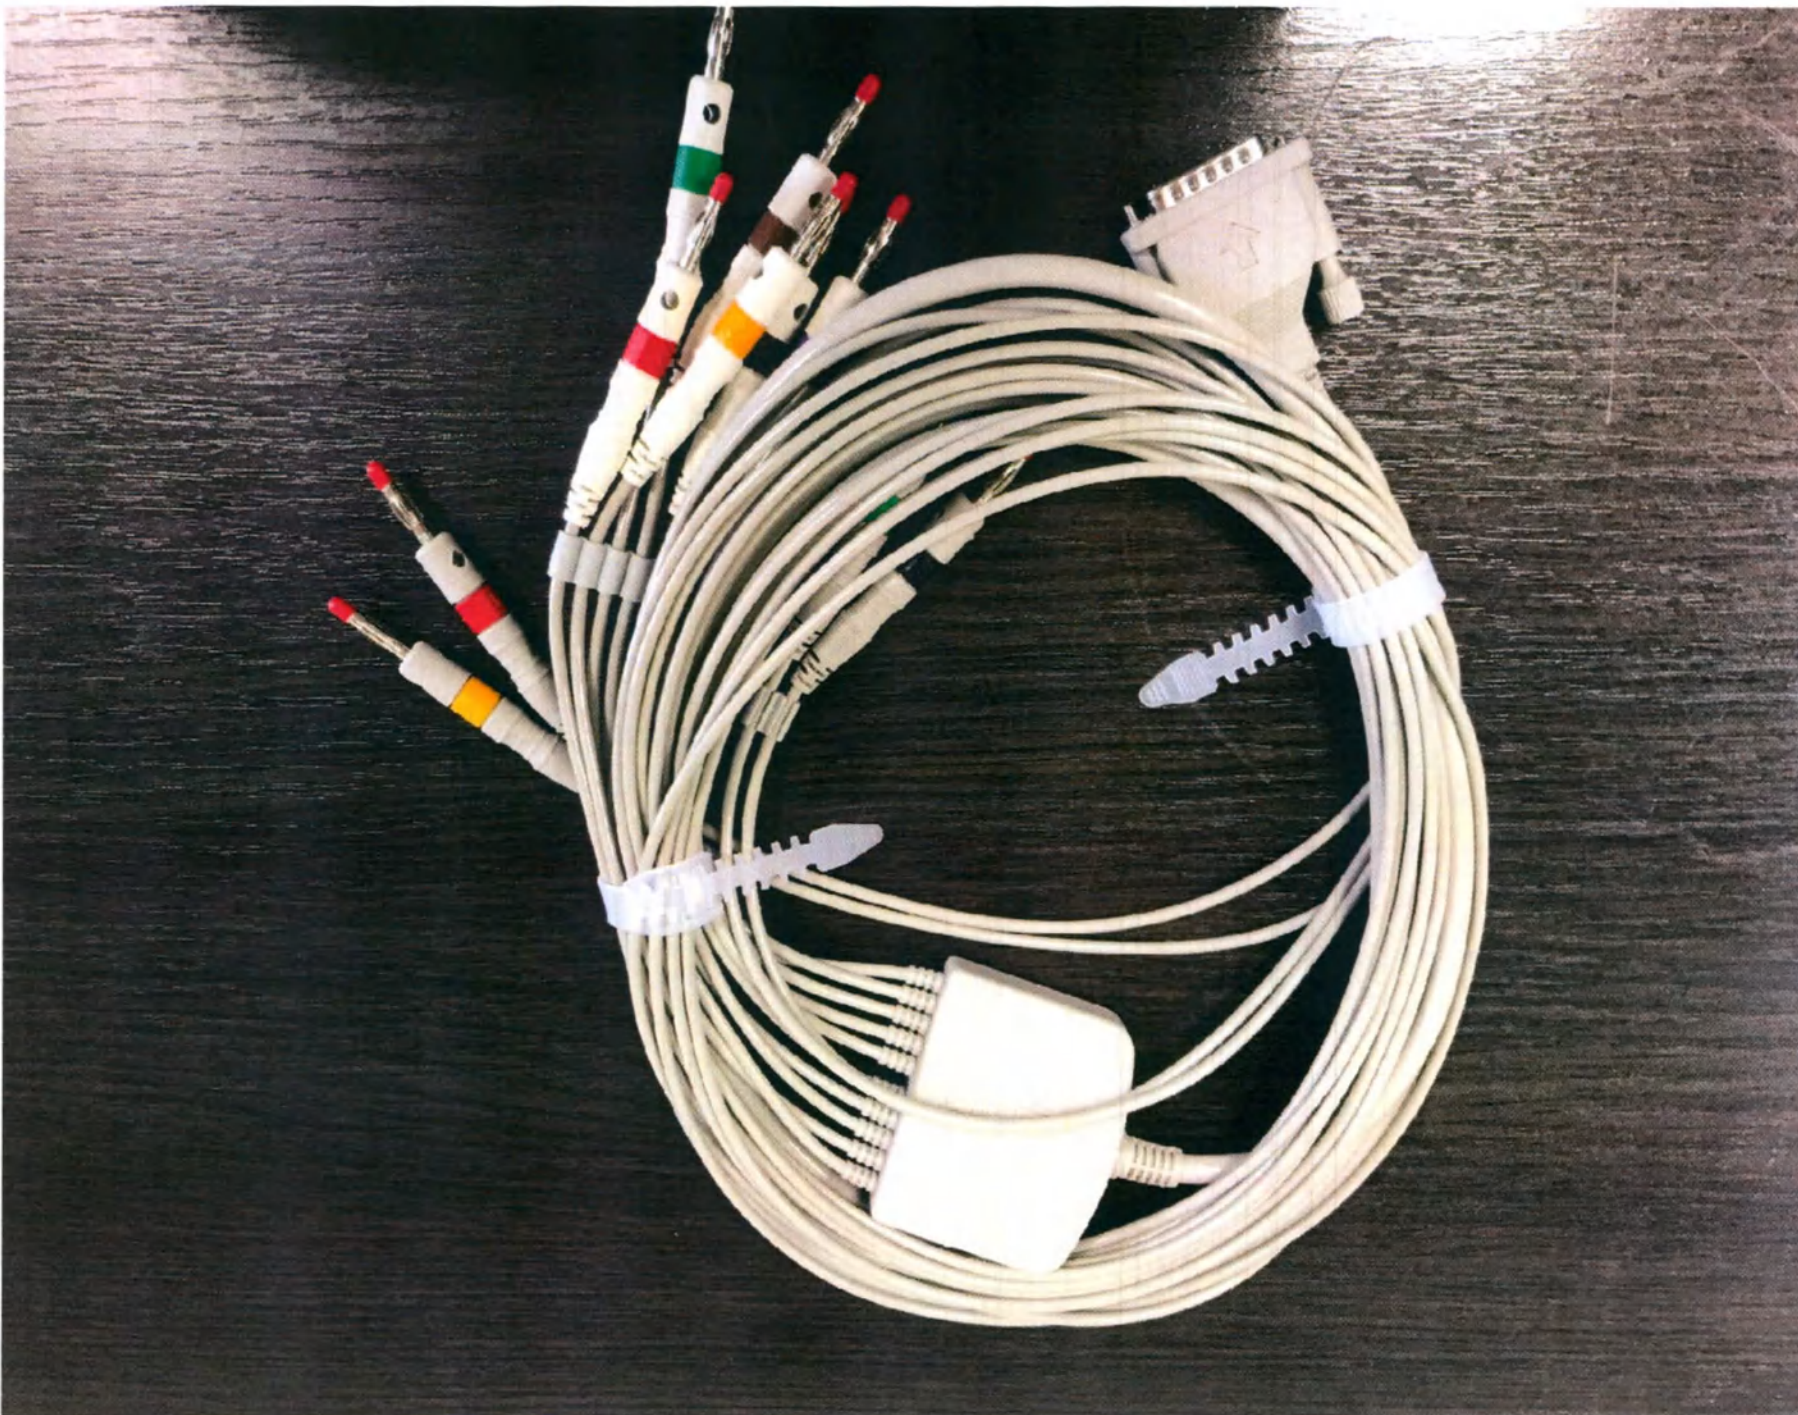

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (общий вид)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (разъем отведений)

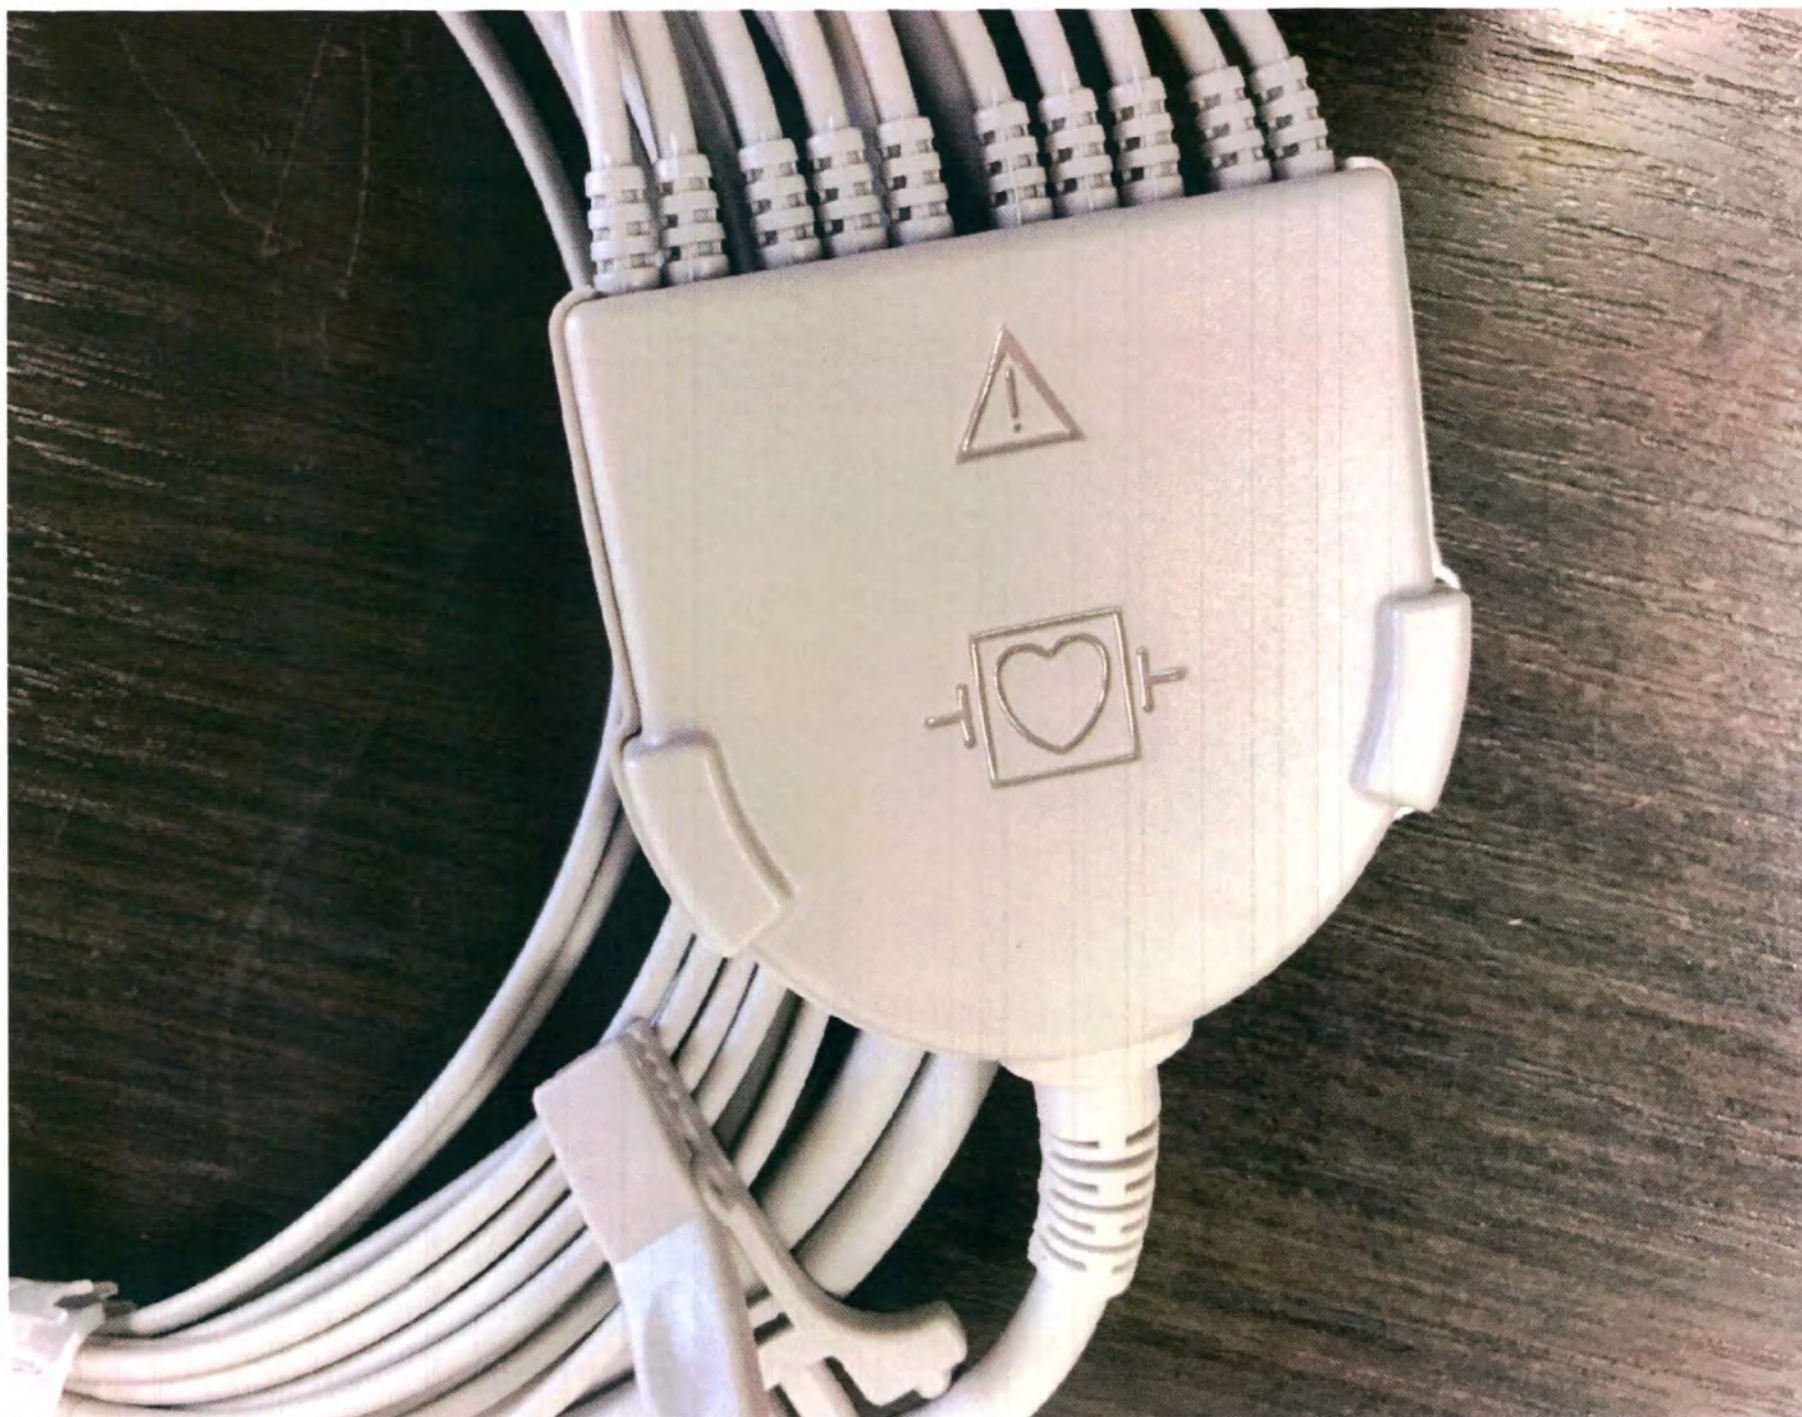

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (маркировка разъема отведений)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (наклейка с серийным номером)



Электрод-клипса для детей (в упаковке)



Электрод-клипса для детей (общий вид)




Электрод-клипса для детей (общий вид сбоку)



LOT ZH22040452211250029

 25.11.2022

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 1
Количество в упаковке – 4 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид)

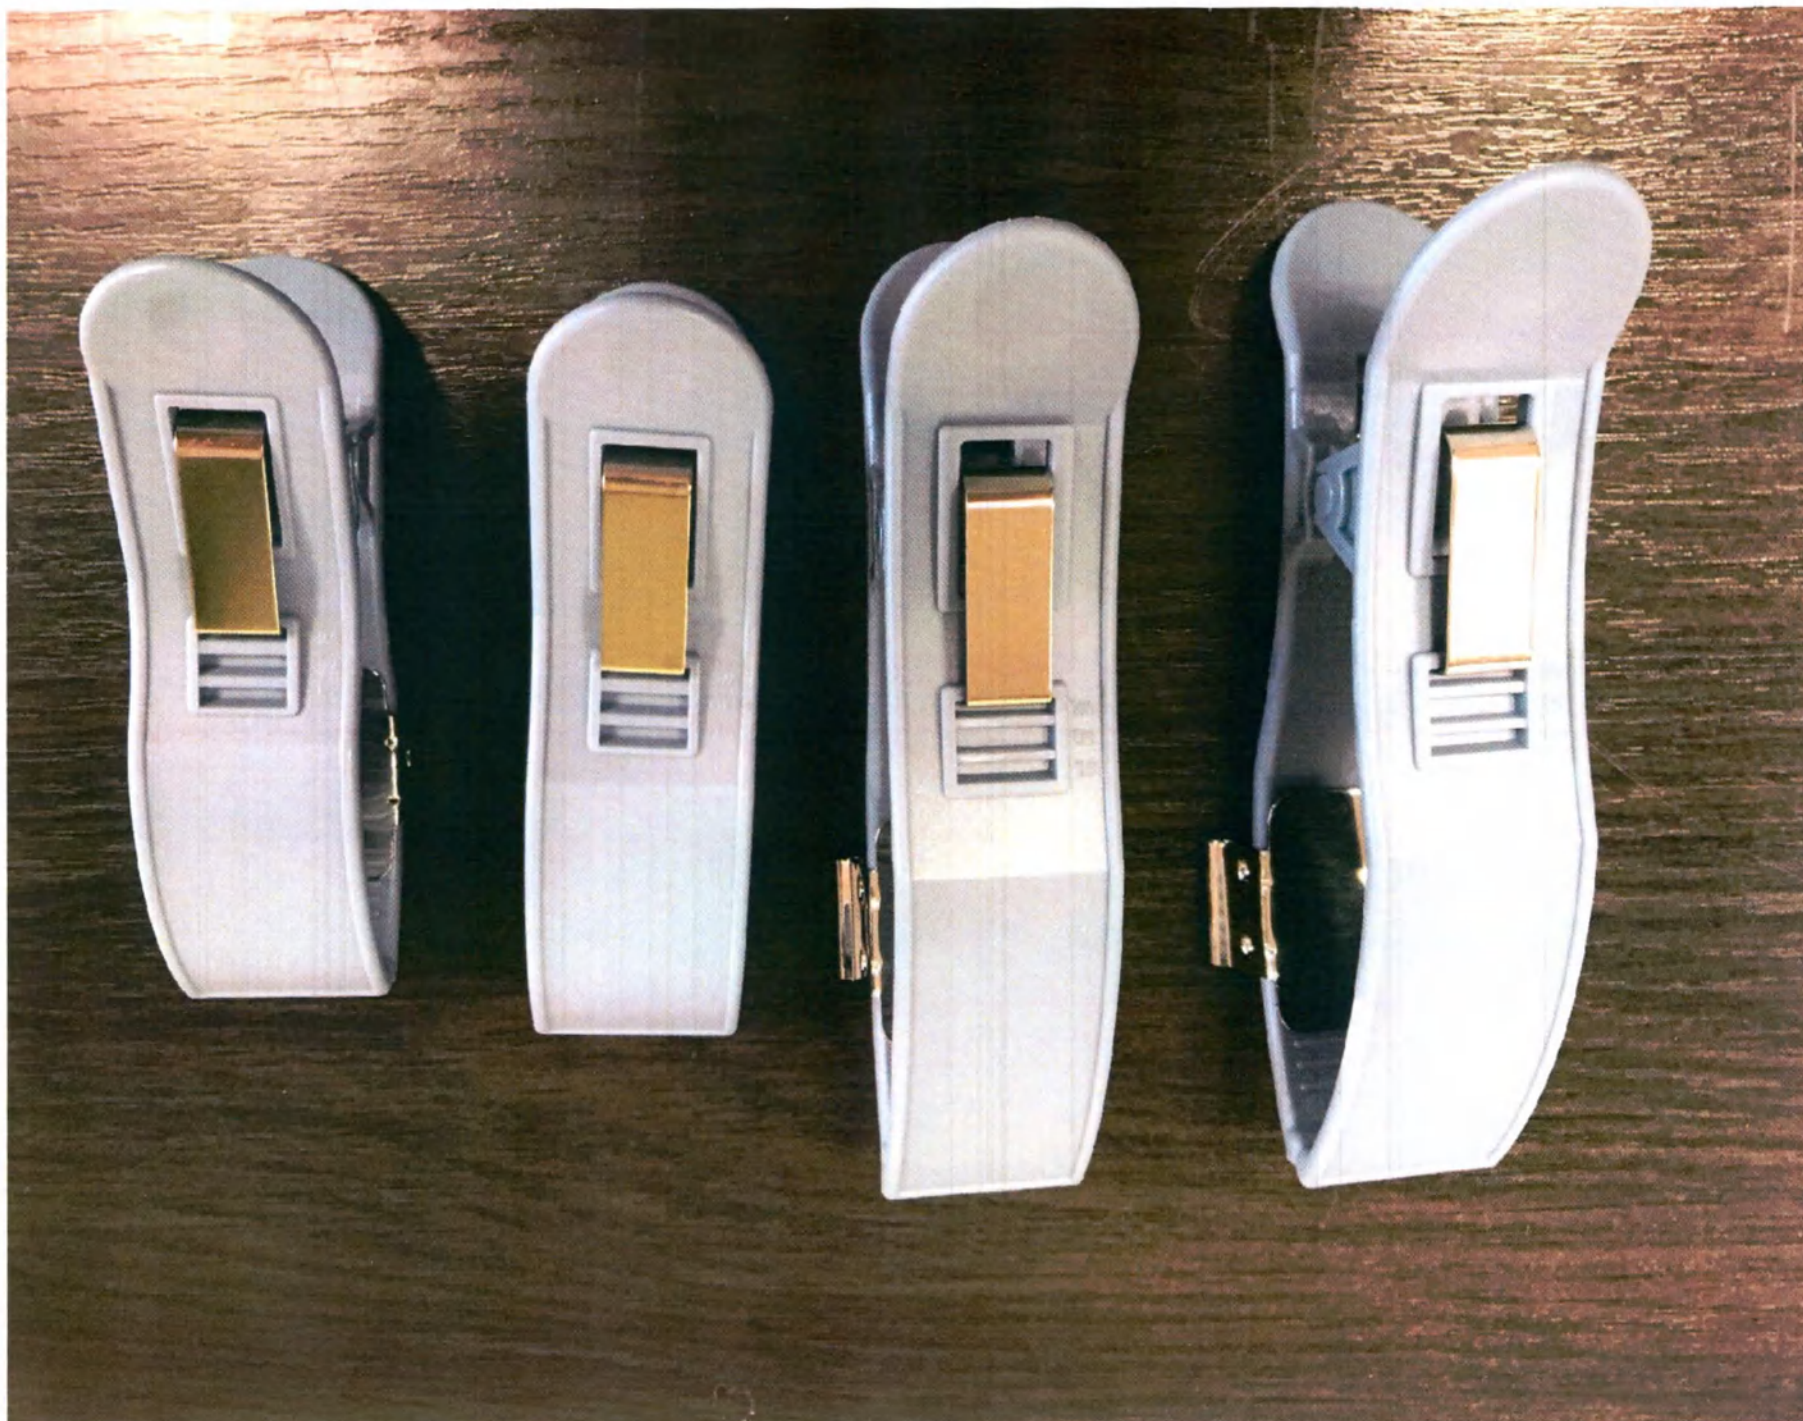

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид сбоку)



LOT 20230222-866

 22.02.2023

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 2
Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 2 (общий вид)




Электрод-груша для детей (в упаковке)



Электрод-груша для детей (упаковка)



Электрод-груша для детей (общий вид)

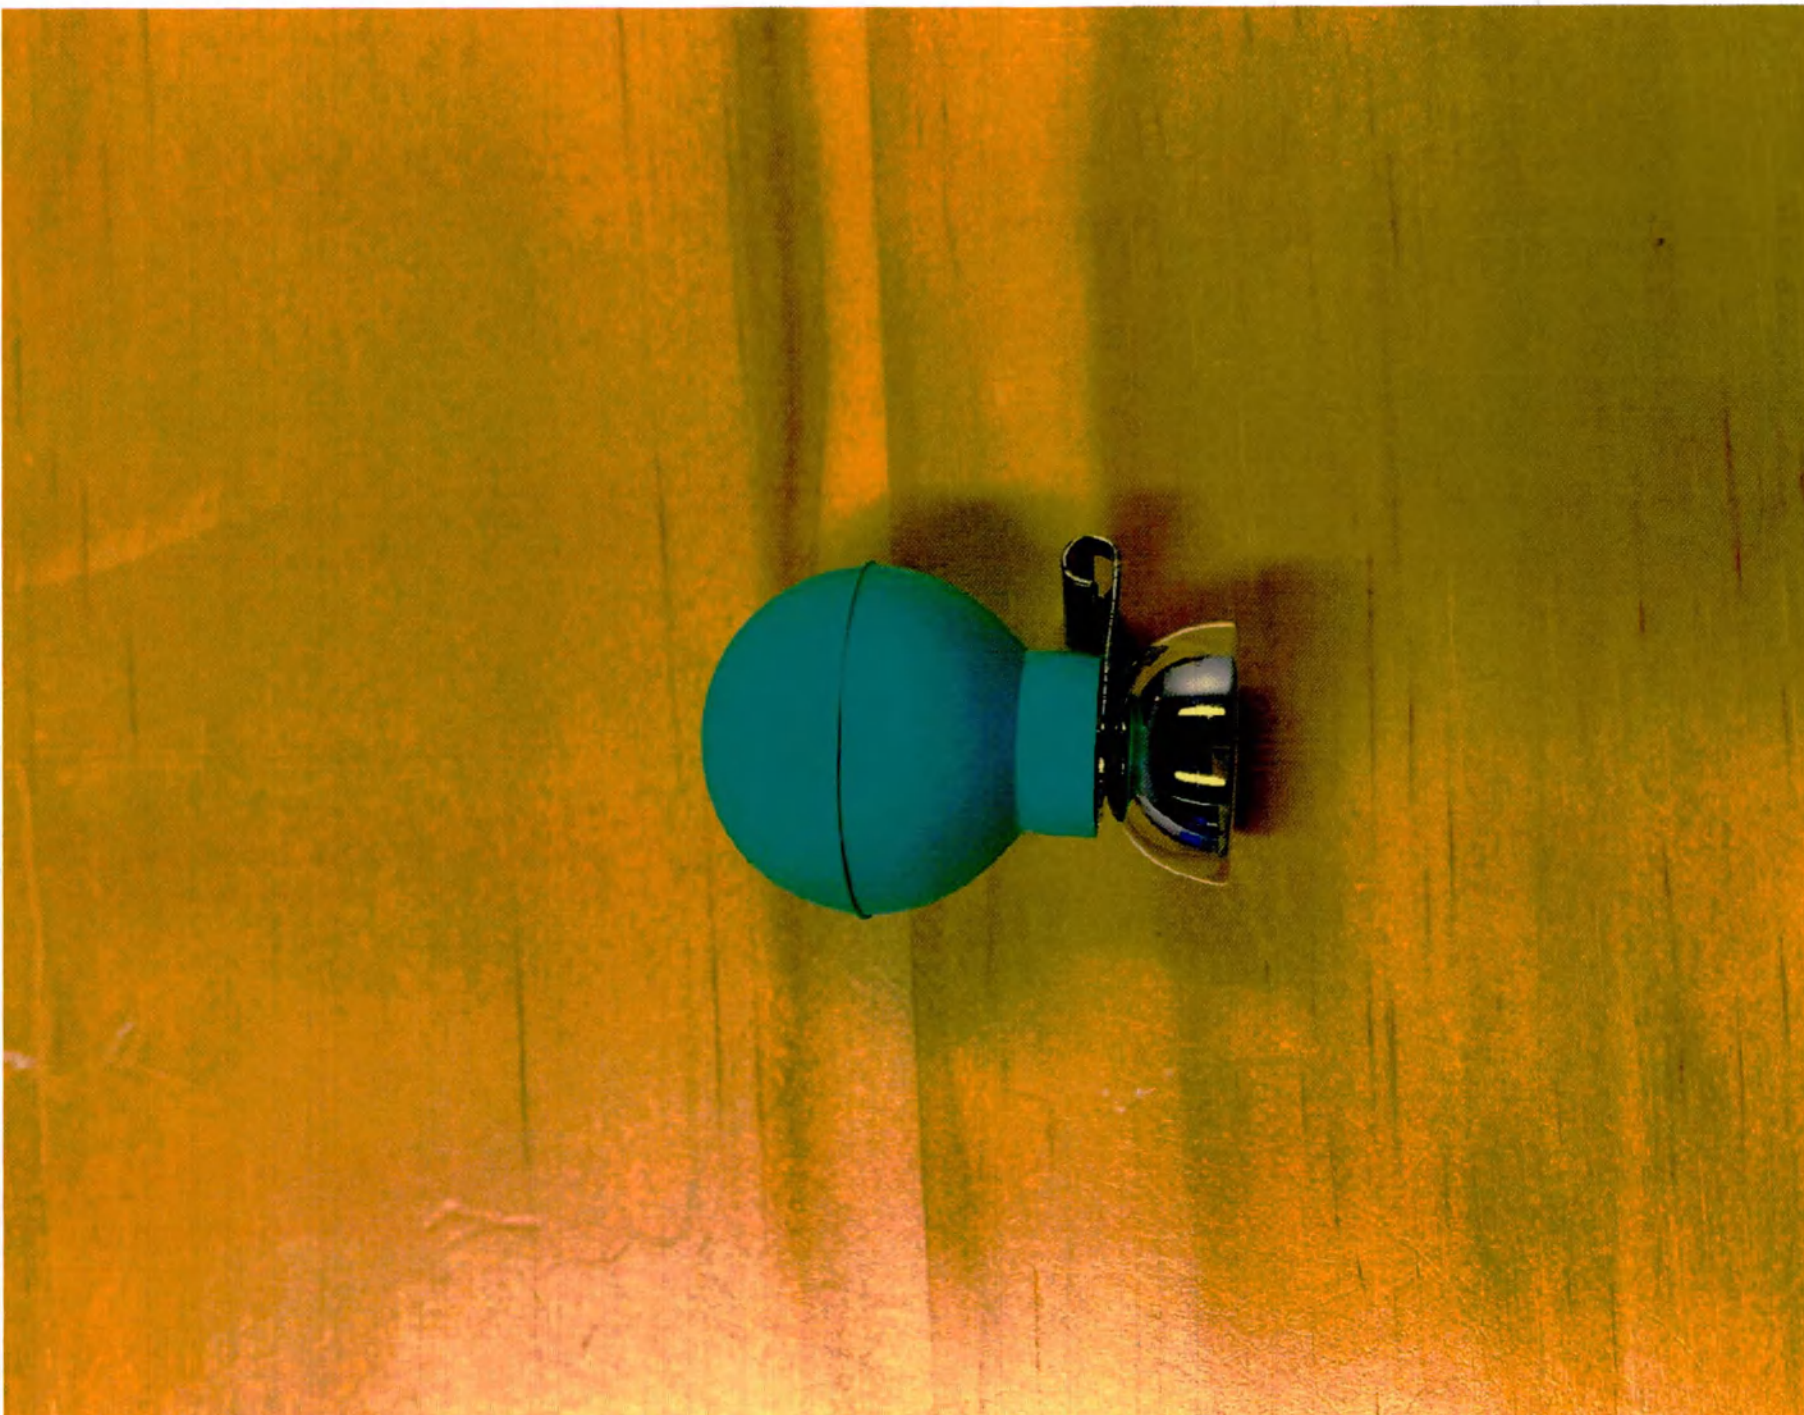

Электрод-груша для детей (общий вид)




Электрод-груша для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 1 (общий вид)



Электрод-груша для взрослых тип 1

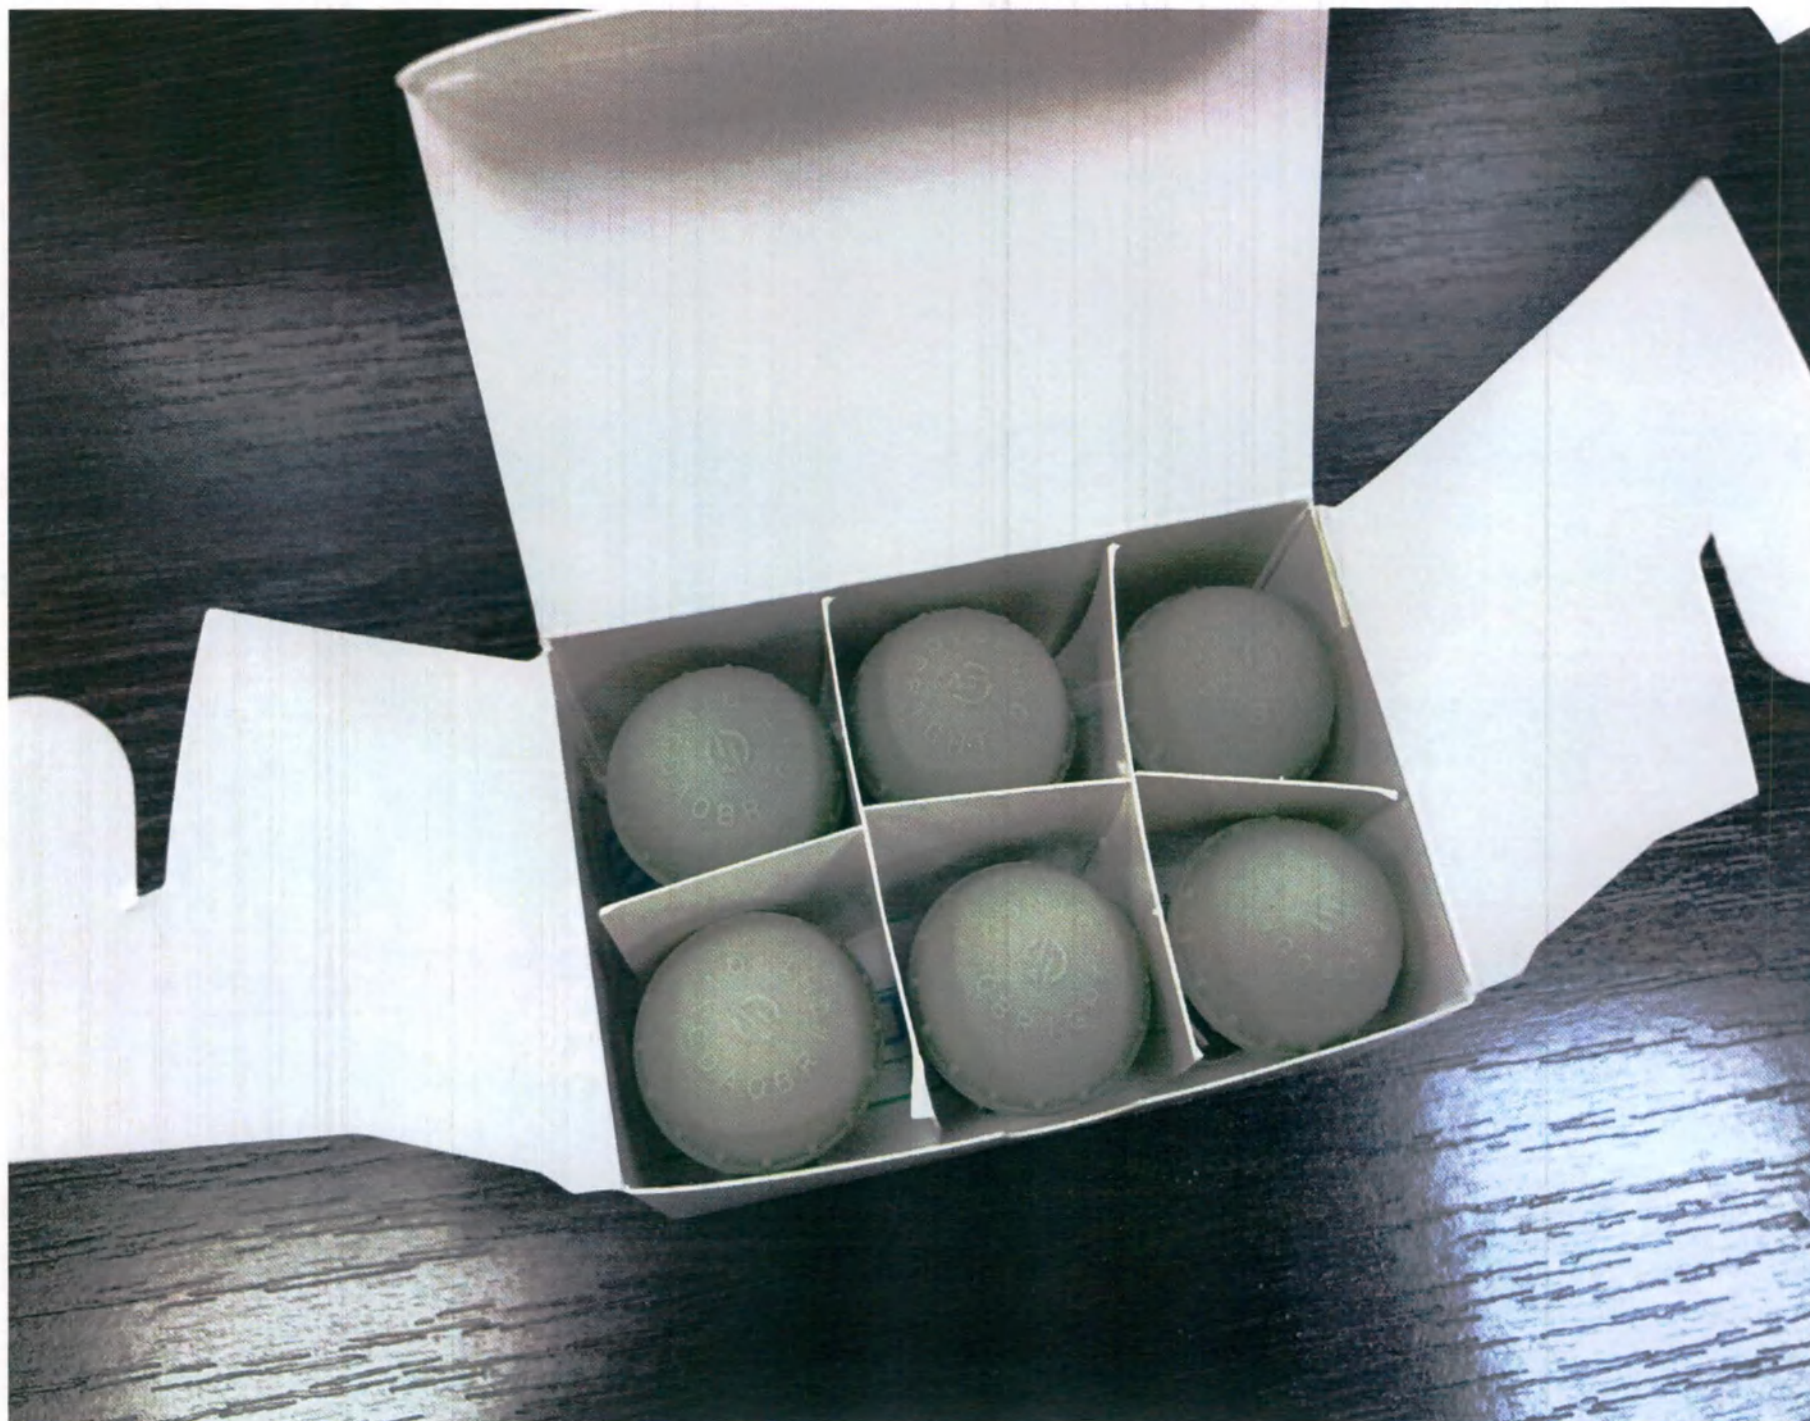

Электрод-груша для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 2 (общий вид)



Электрод-груша для взрослых тип 2

LOT 22110400017



30.10.2022

COMEN




Электрод-клипса для детей
Количество в упаковке – 4 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China


Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

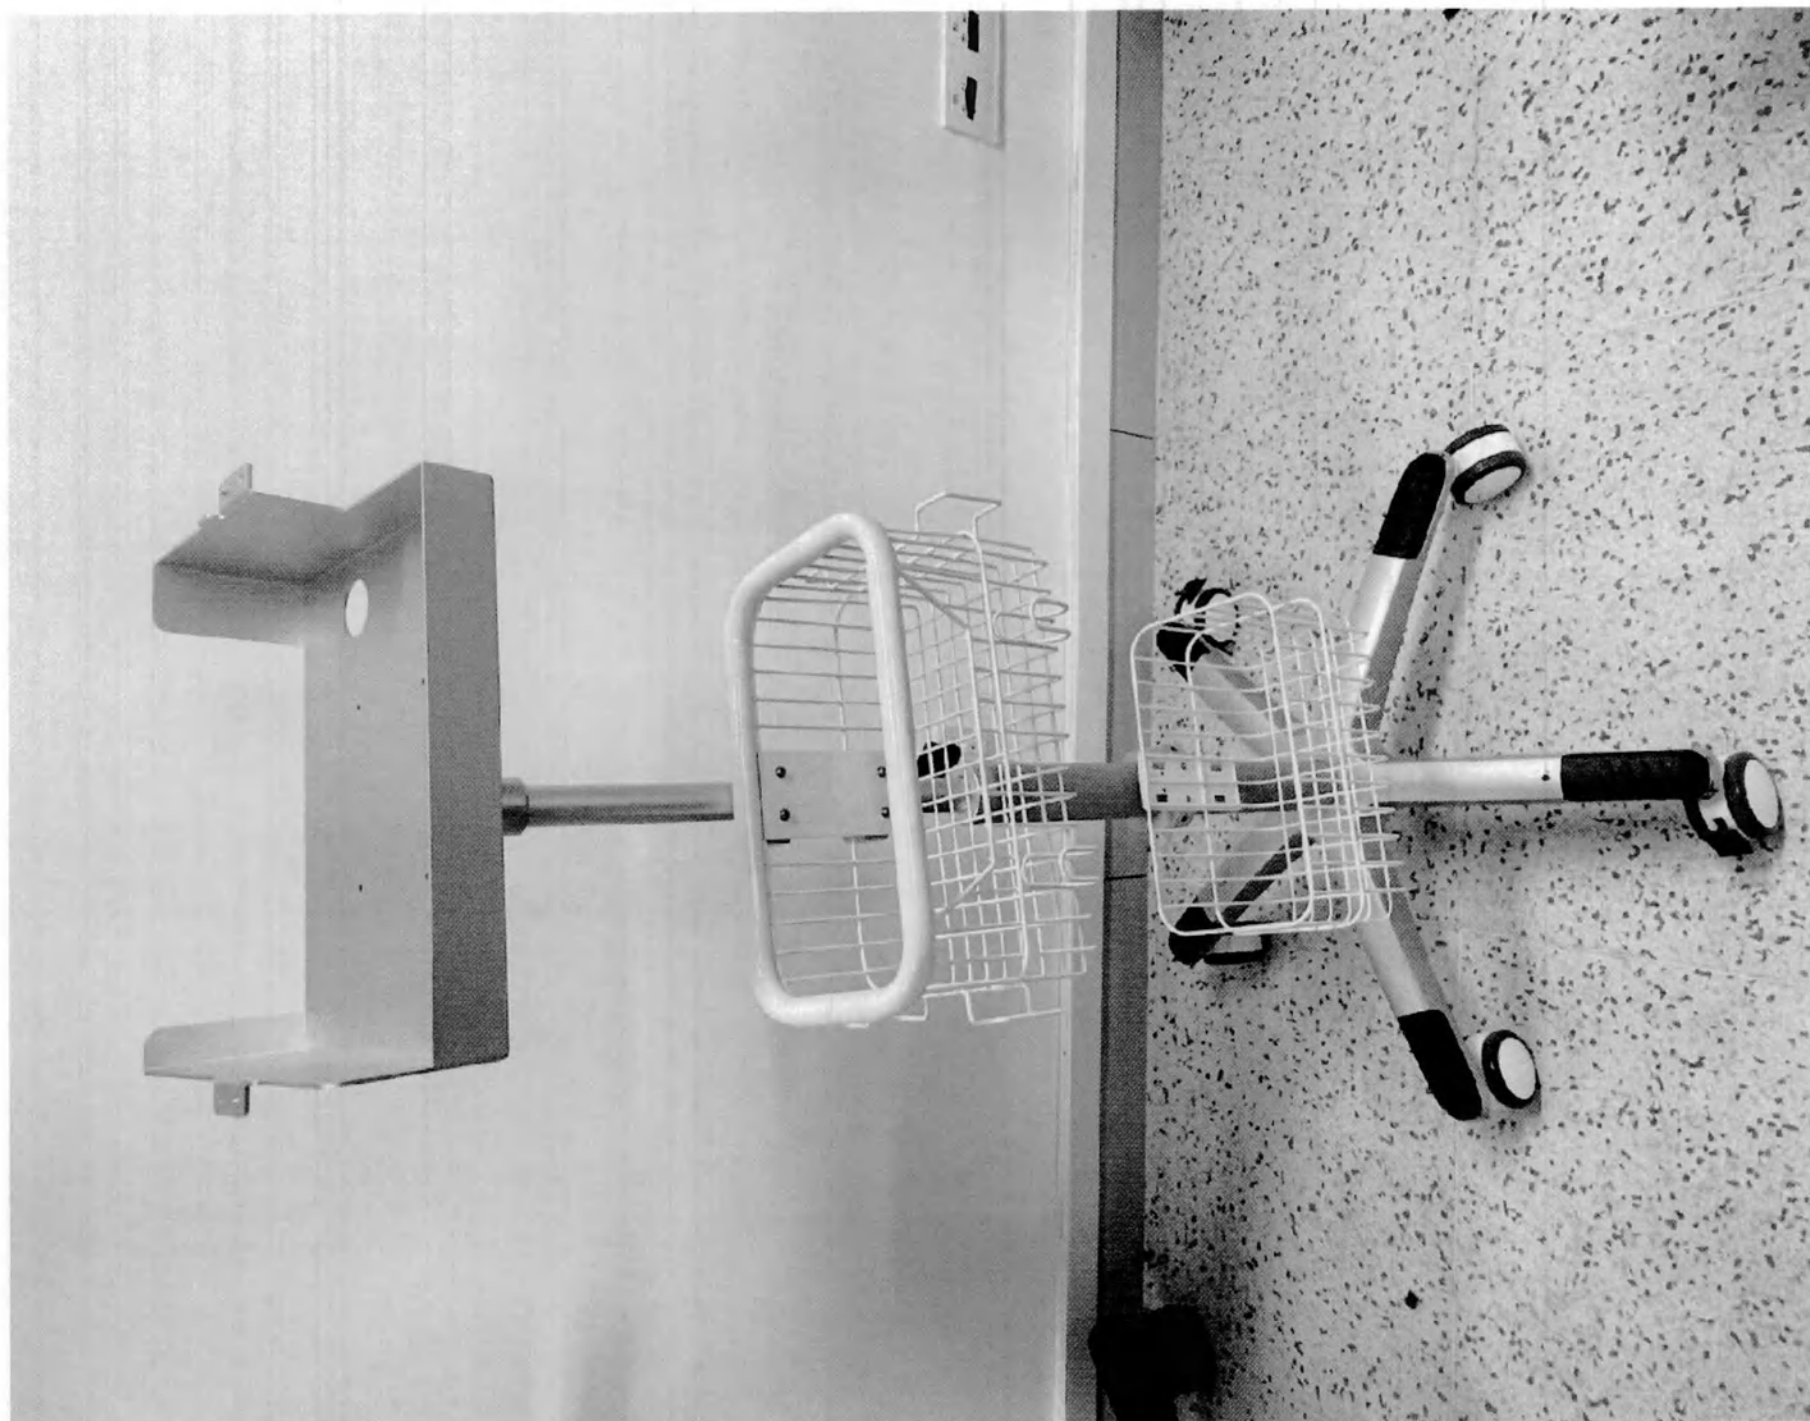

Тележка для ЭКГ модели СМ1200В

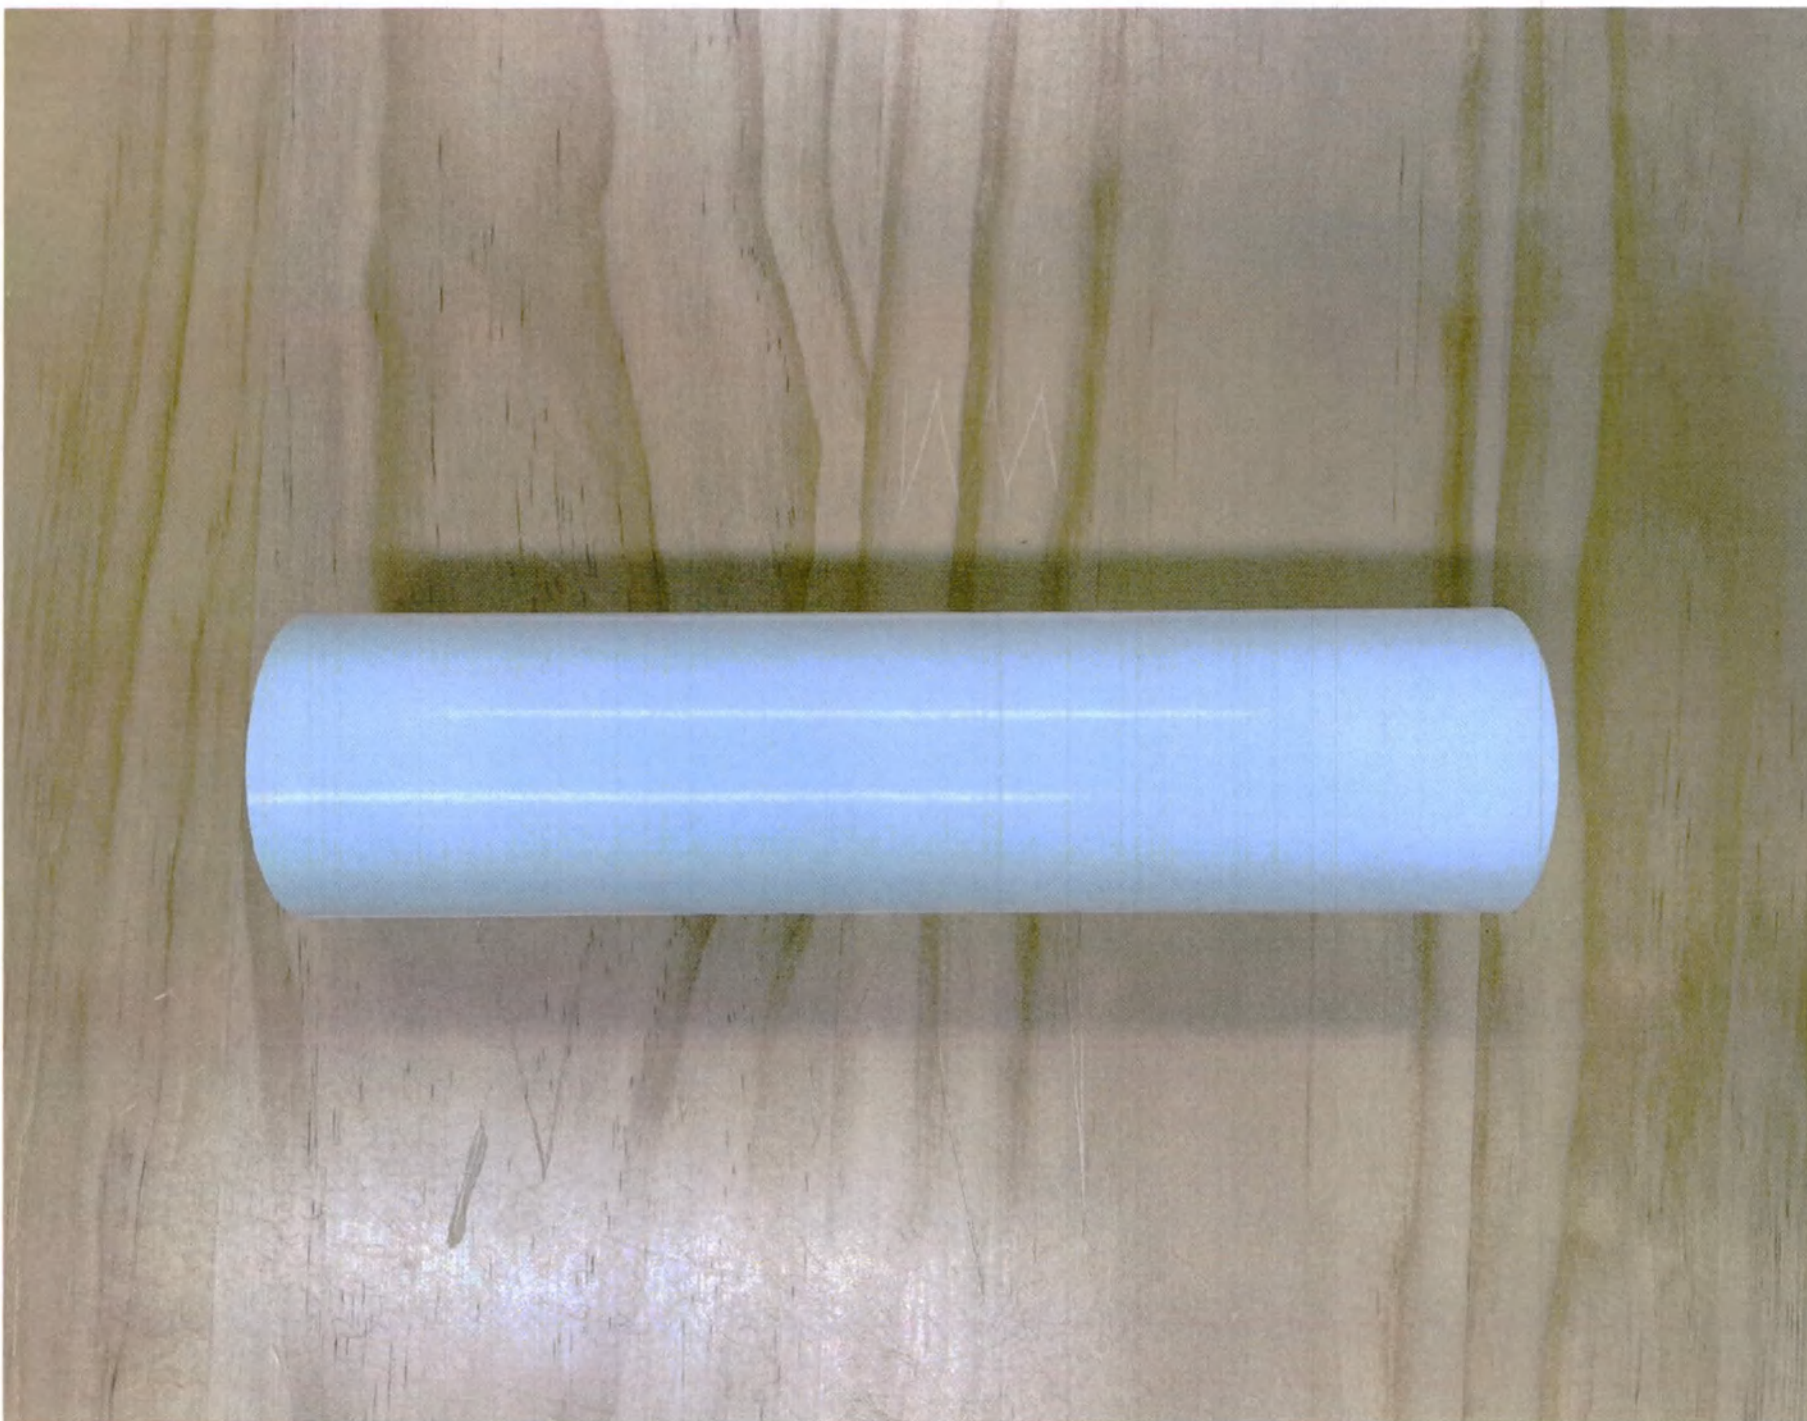

Бумага для печати для моделей CM1200A, CM1200B

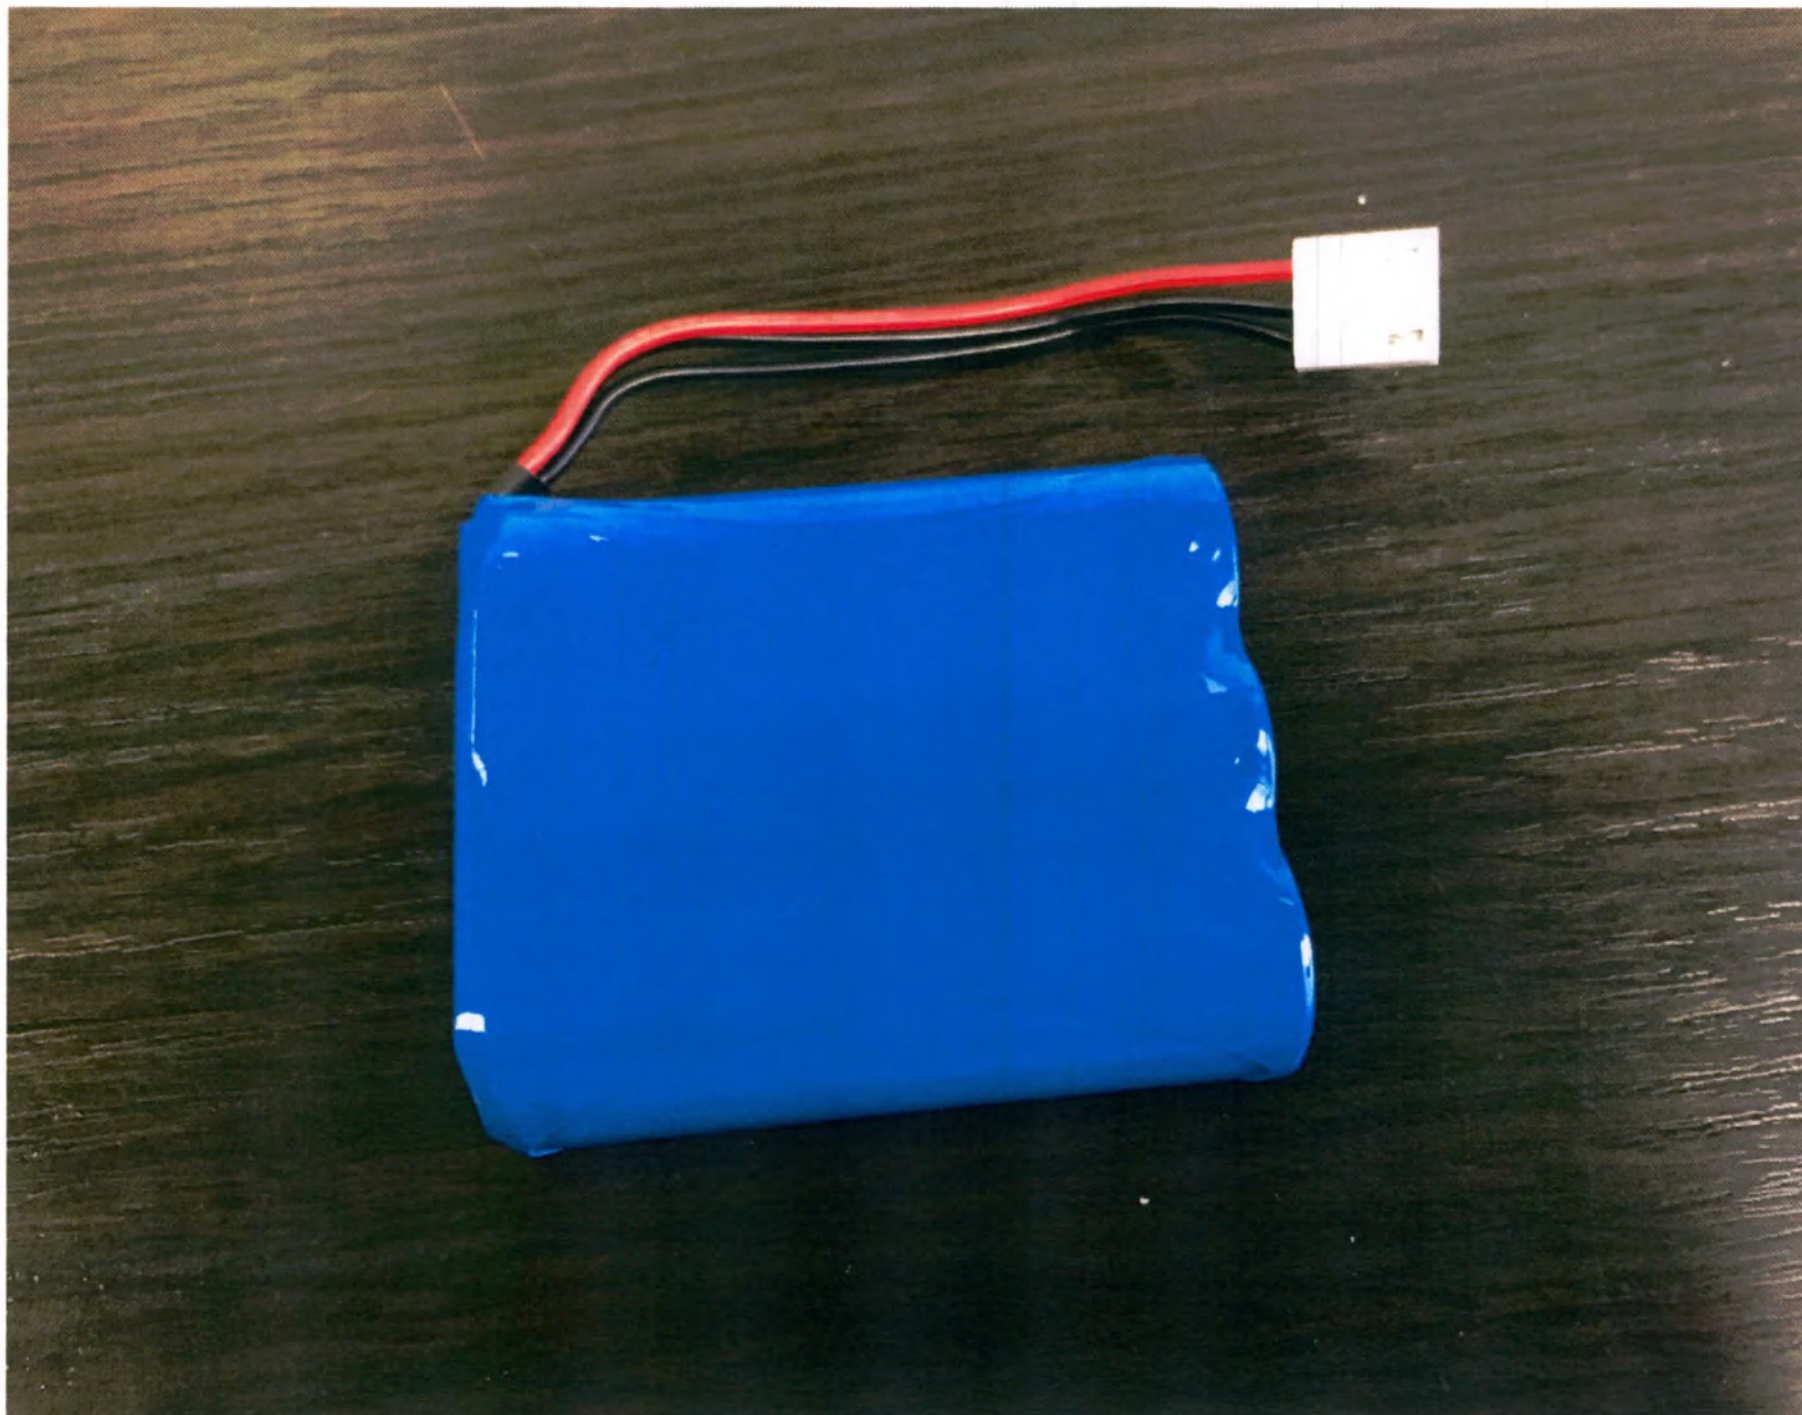

Батарея литиевая для моделей CM1200B, H3

可充电锂离子电池
Rechargeable Li-Ion Battery

COMEN
深圳市科曼医疗设备有限公司
SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Model: CMLI1X3N001A

3ICR19/65

11.1V === 2200mAh/24Wh

MADE IN CHINA
中国制造



(序列编号)



(YYYY-MM-DD)



SHR082012202207140015

2022-07-14-20


警告：

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C(-4°F)至60°C(140°F)温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。推荐使用的最高环境温度为45°C(125°F)。


CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Don't crush, puncture, disassemble or short circuit the battery in -20°C(-4°F) to 60°C(140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use. Maximum Recommended Ambient is 45°C(125°F).

Батарея литиевая для моделей CM1200B, H3 (маркировка)

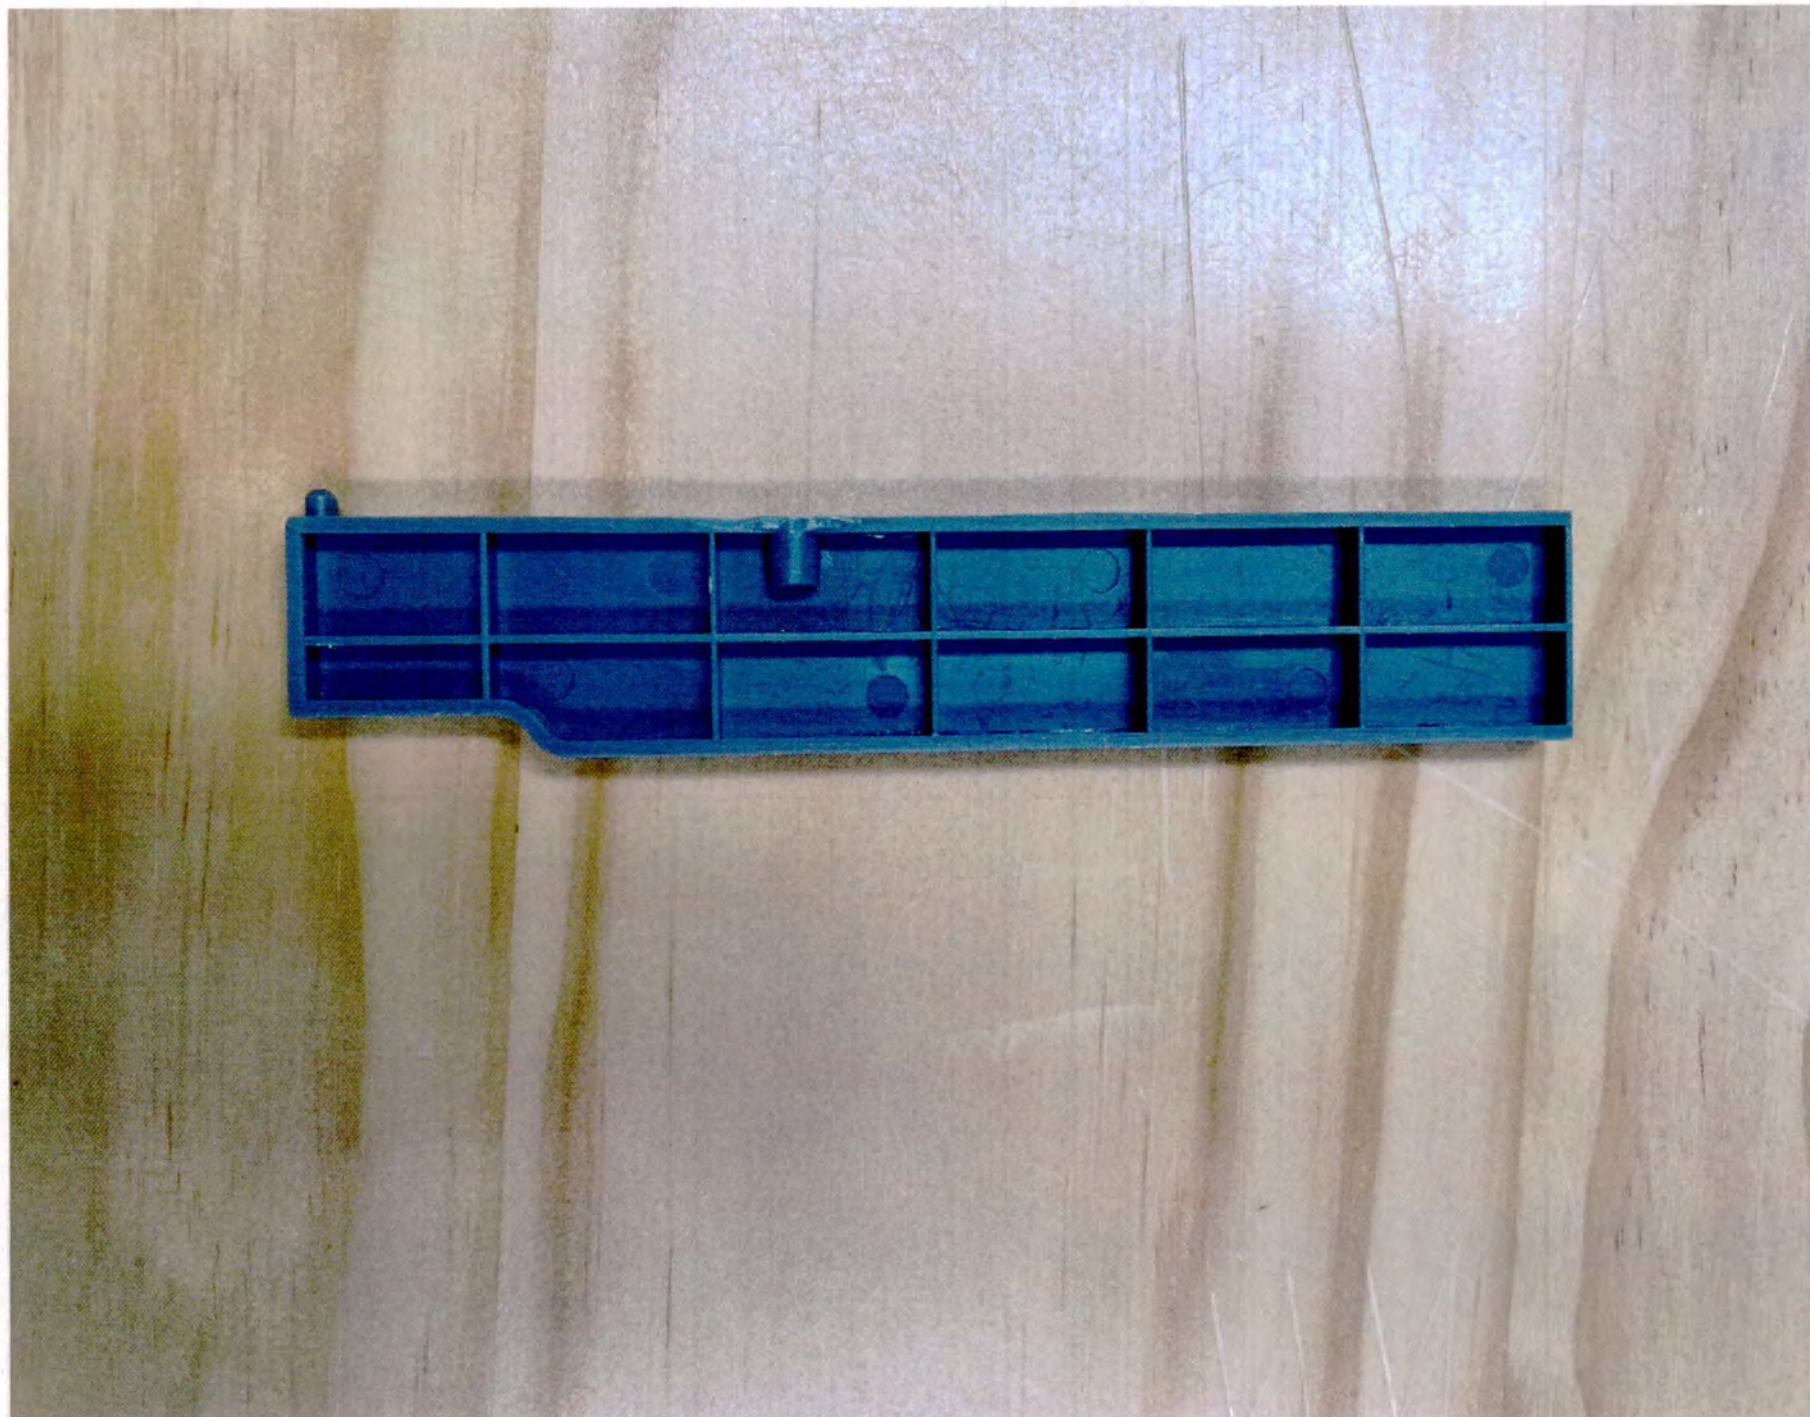

Планка принтера фиксирующая для модели CM1200B

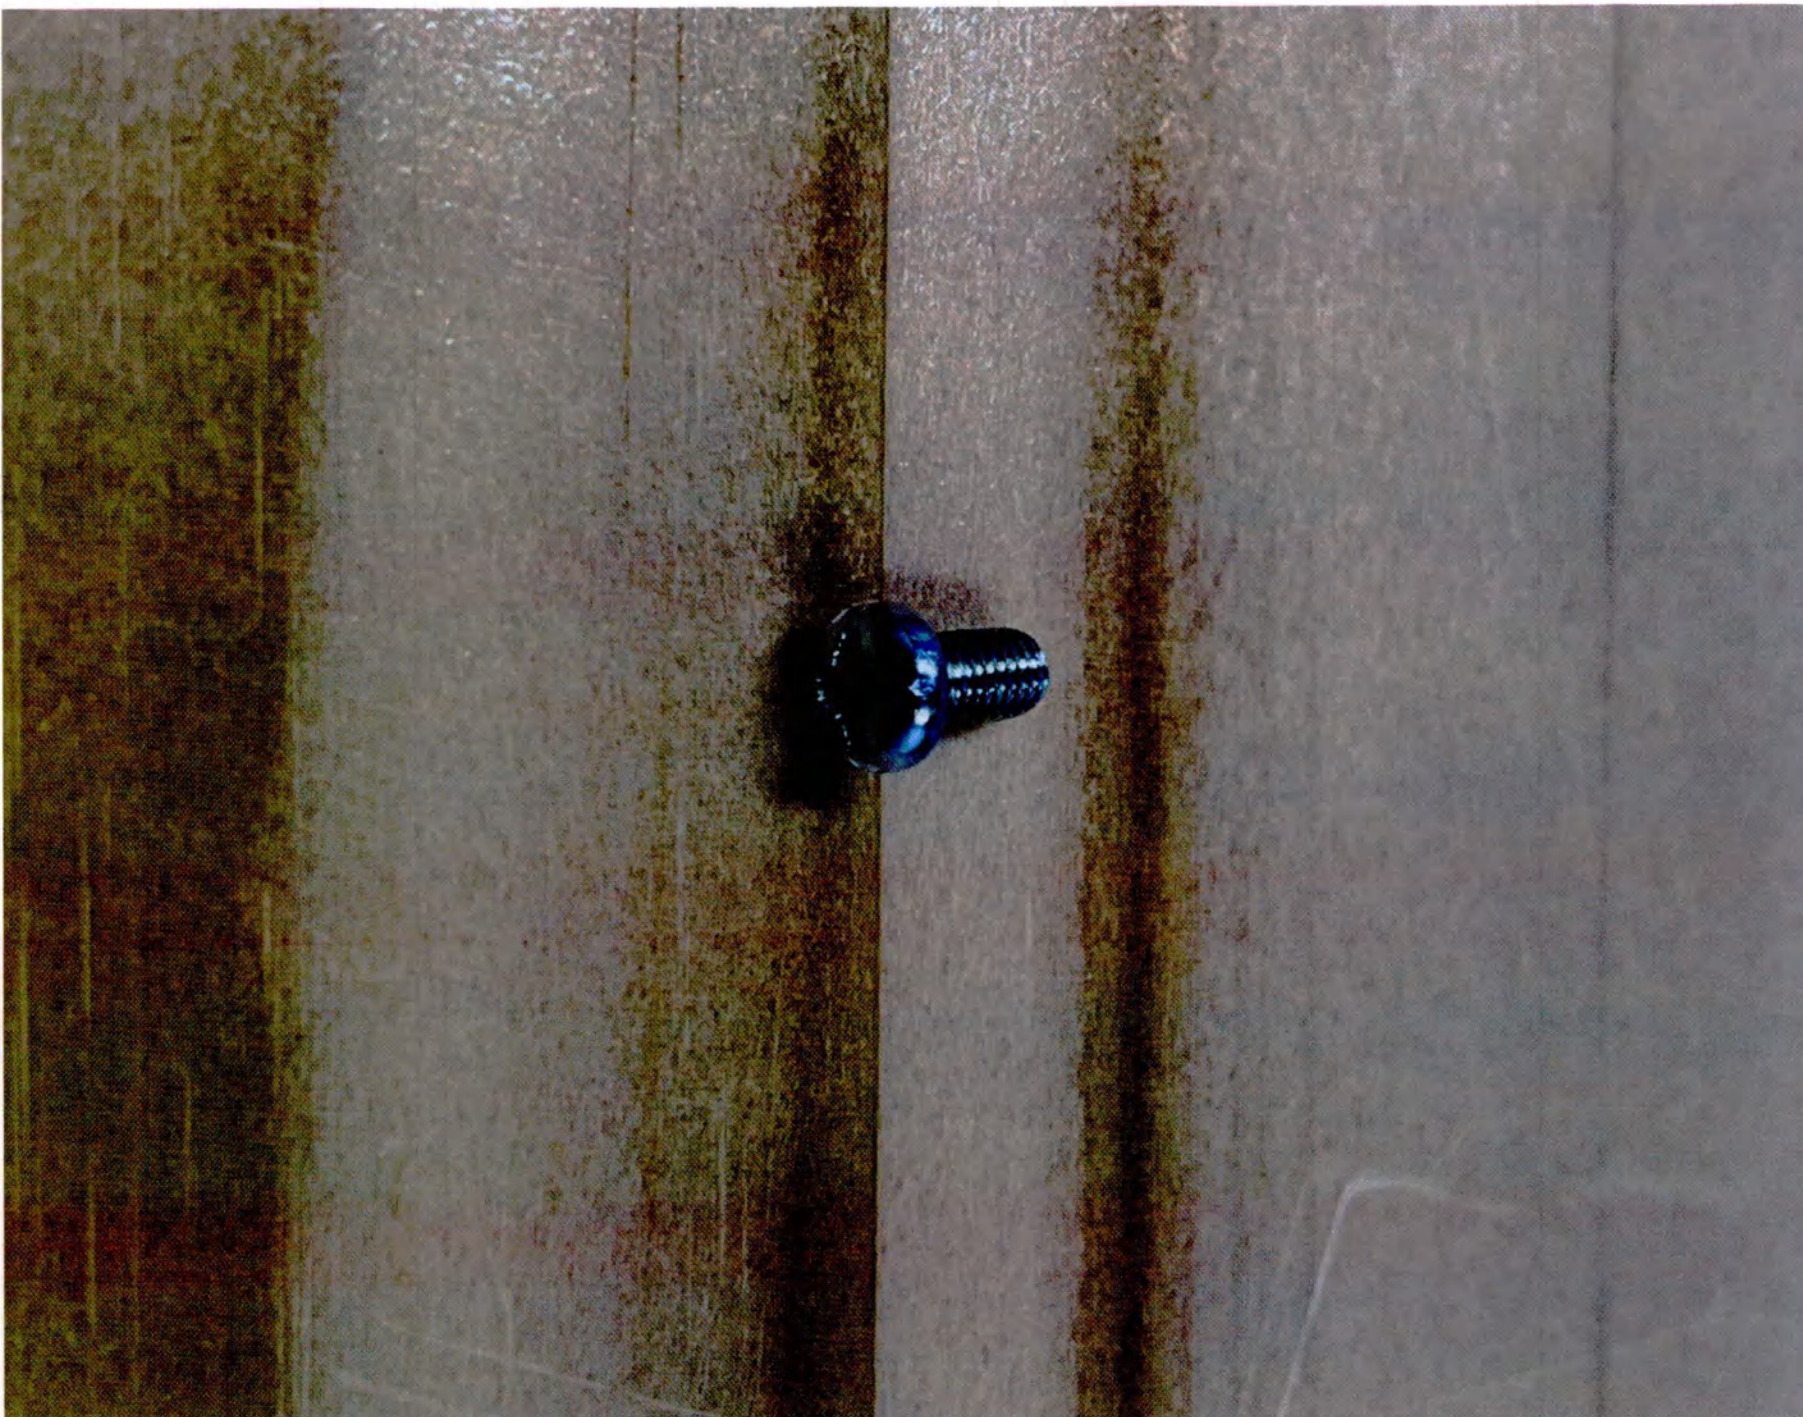

Винты крепежны

ВСЕГО ПРОШИТО
И СКРЕПЛЕНО

128



В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109012, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Электрокардиограф, в вариантах исполнения

Электрокардиограф НЗ

Электрокардиограф Н12

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»



Кизилова А.М.

Электрокардиограф НЗ



Электрокардиограф НЗ: транспортная/потребительская коробка



Электрокардиограф НЗ: манипуляционные надписи и знаки на транспортной/потребительской коробке

MODEL: **H3**
DATE: **2022.08.30**
NUMBER: **H3220830002**
ORDER NO#: **FG20220721**



H3220830002

Электрокардиограф H3: идентификационная наклейка на транспортной/потребительской коробке

COMEN

Электрокардиограф НЗ

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Размер упаковки: 317мм (длина)х 258мм (глубина) 285мм (высота)

Масса нетто: 2,2 кг Масса брутто: 2,5 кг Количество в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)


Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.


6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMIT




HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION


Электрокардиограф НЗ: маркировка транспортной/потребительской коробки

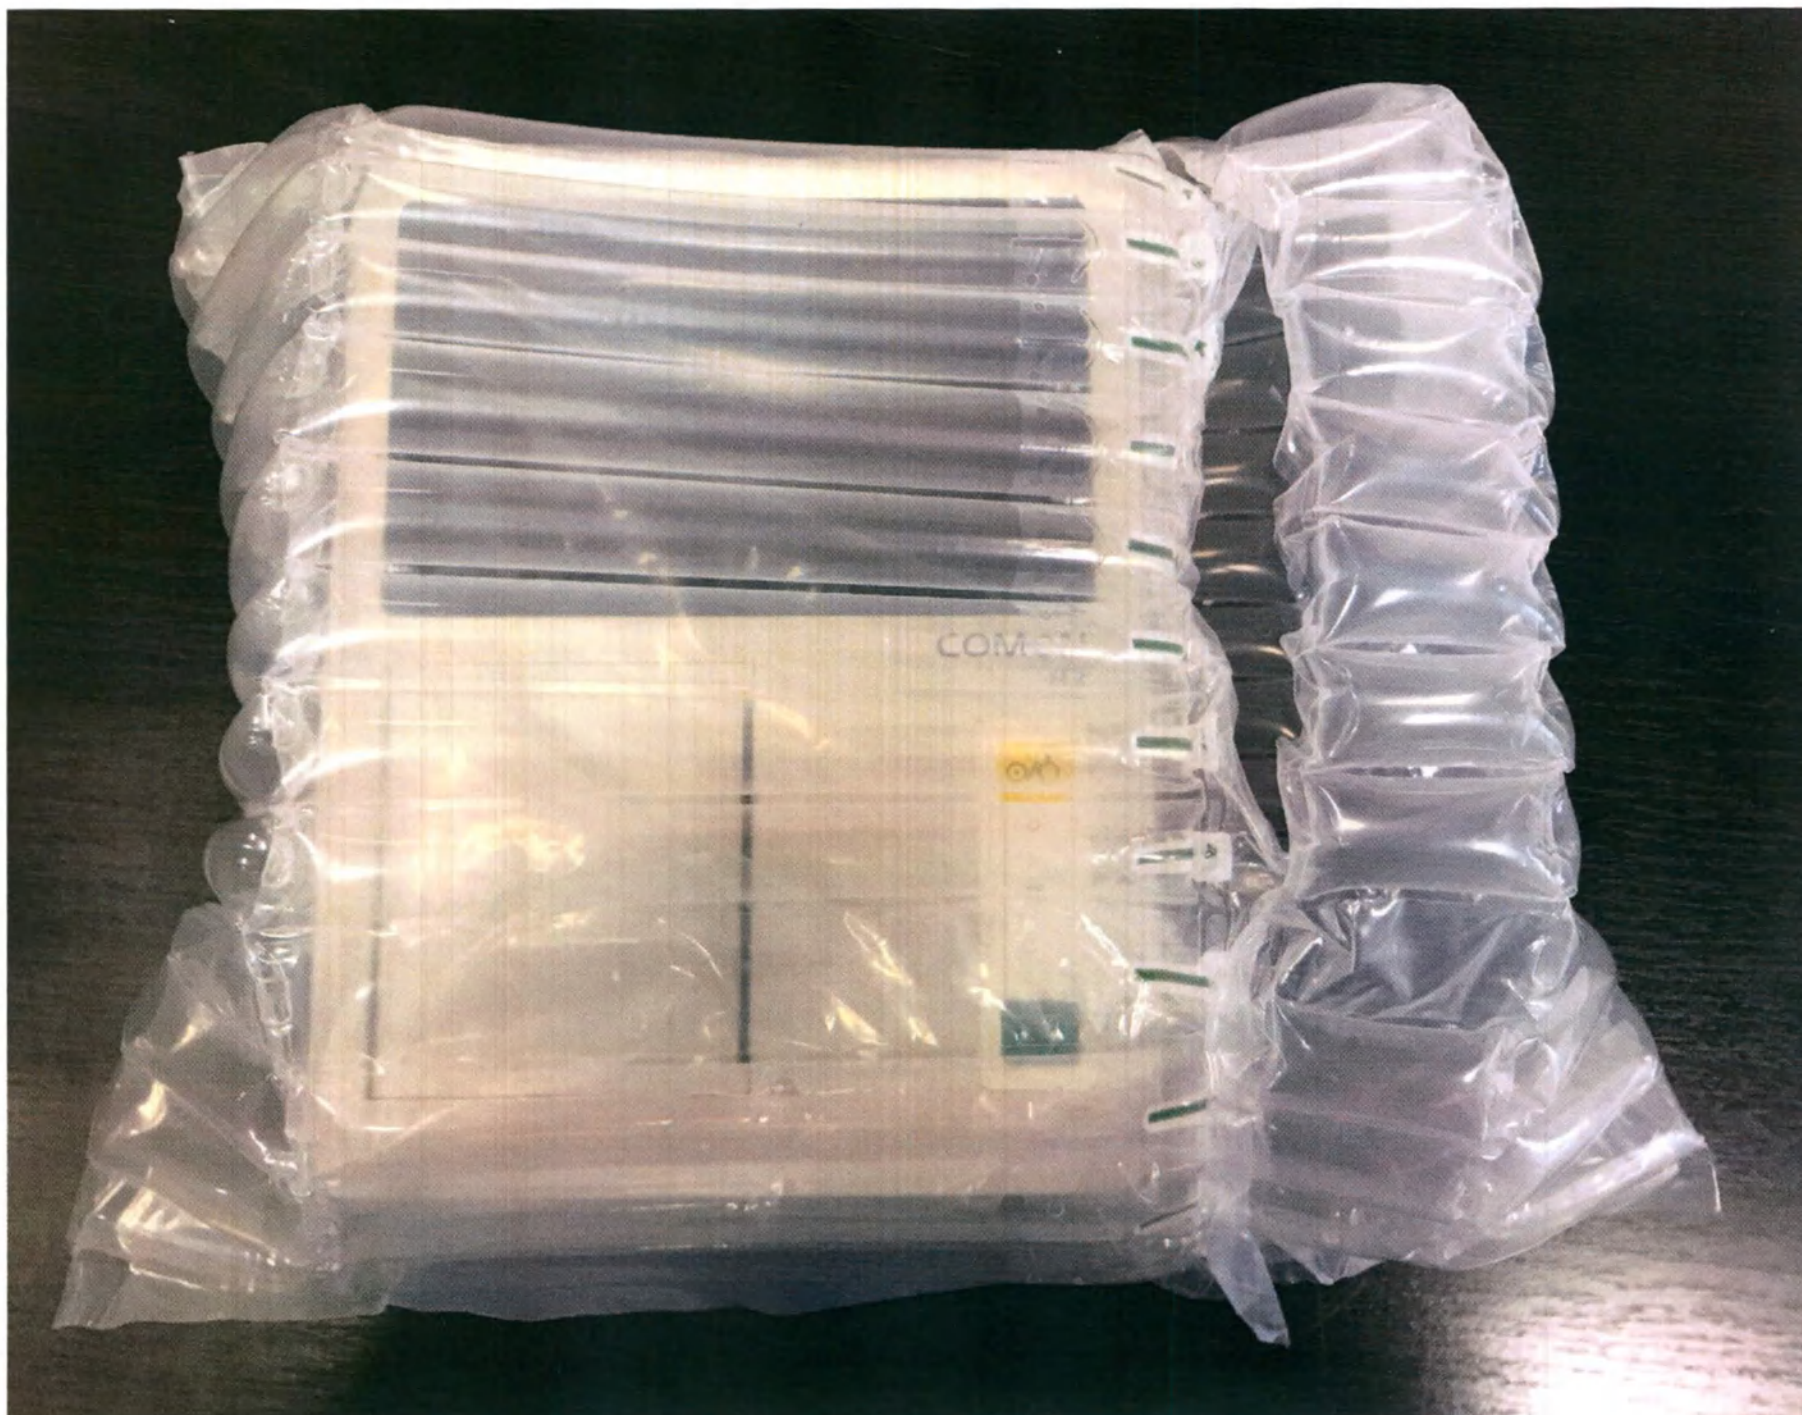


Блок базовый НЗ (в воздушных пакетах для предотвращения повреждений)




Блок базовый НЗ (вид сверху, передняя панель)

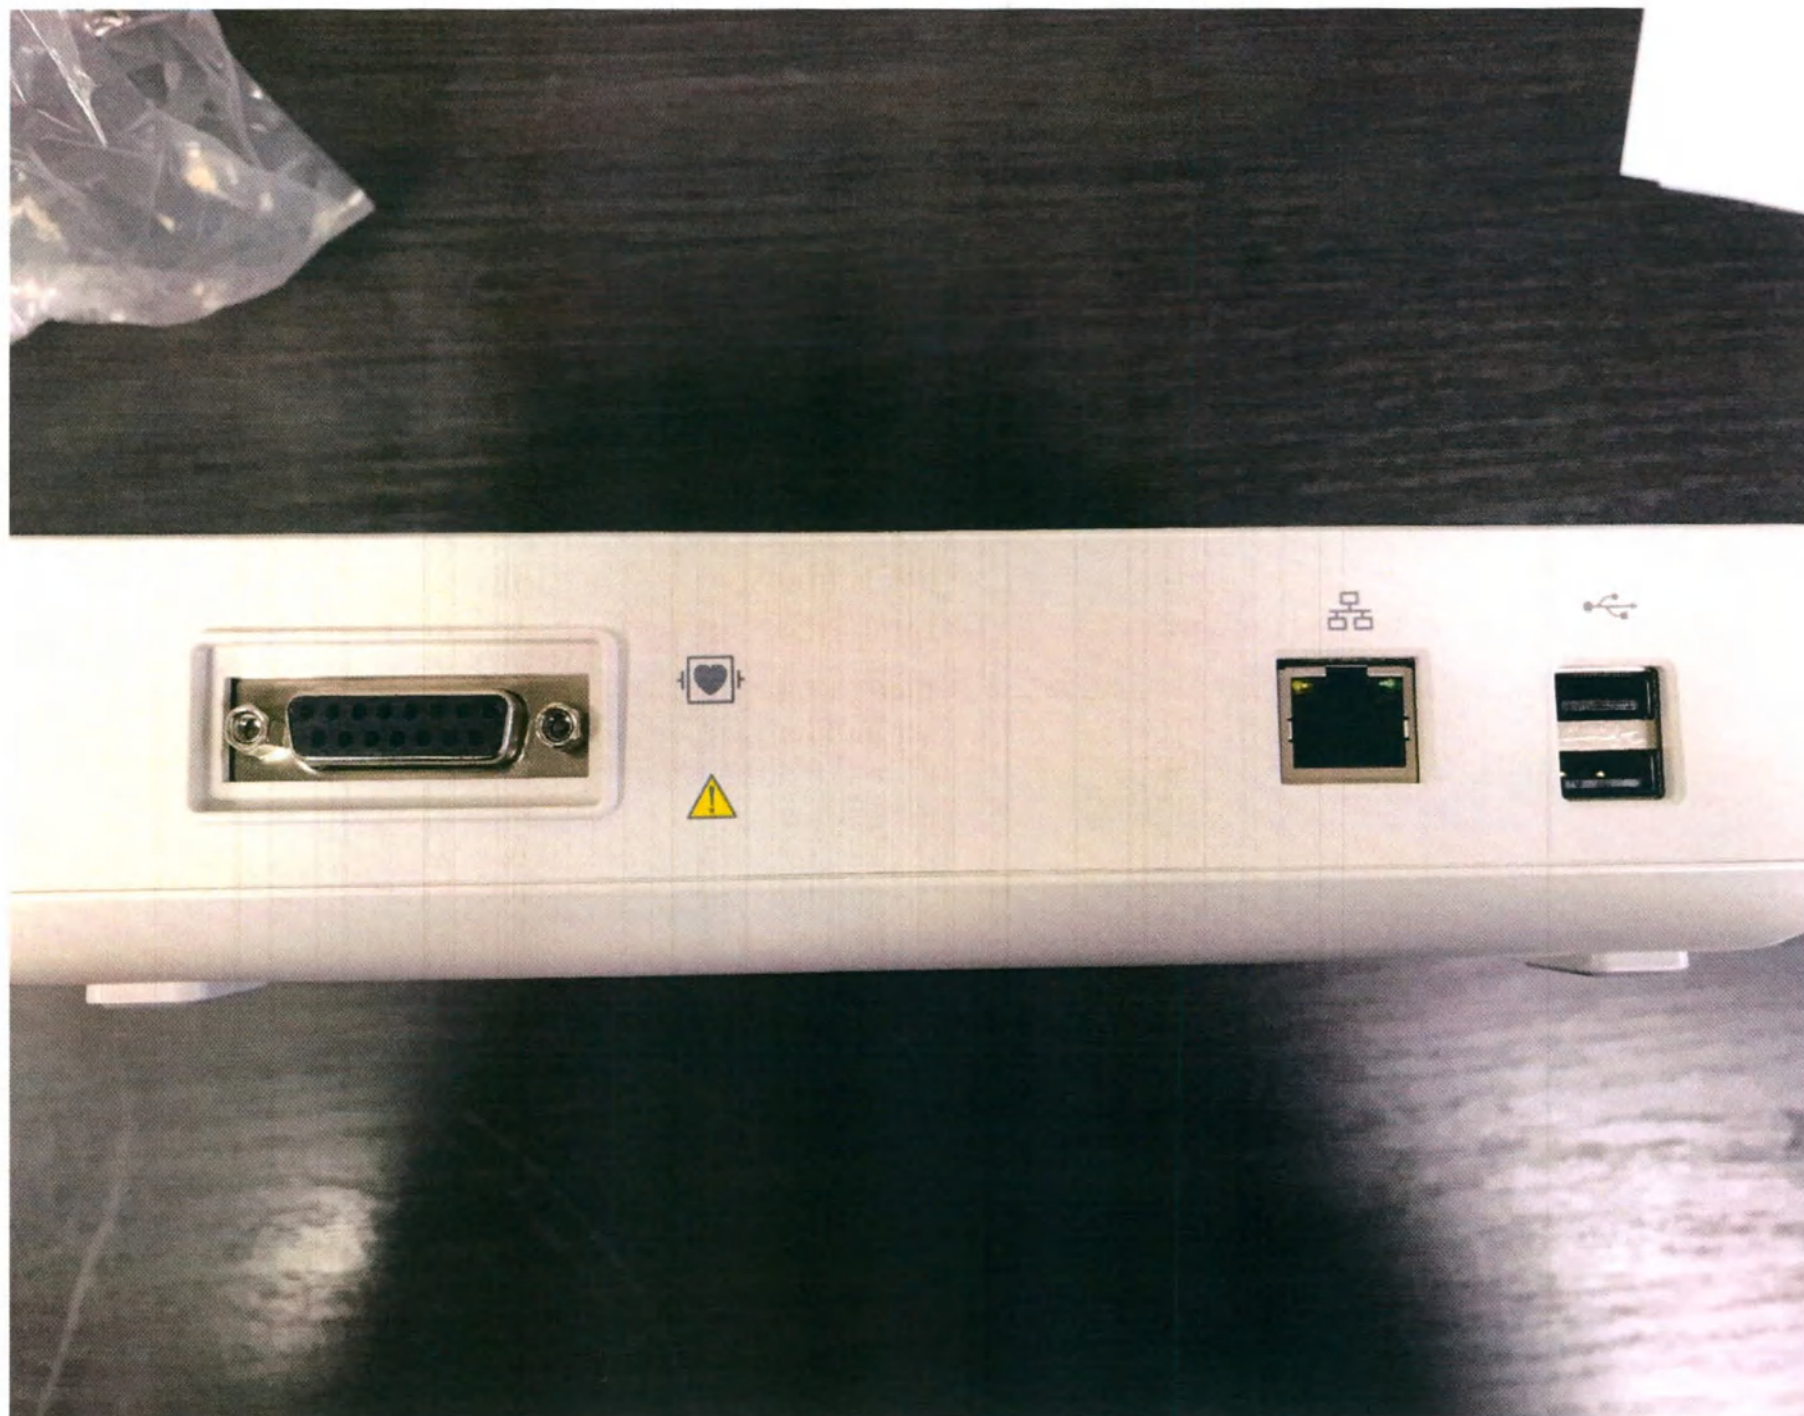

Блок базовый НЗ (вид спереди)

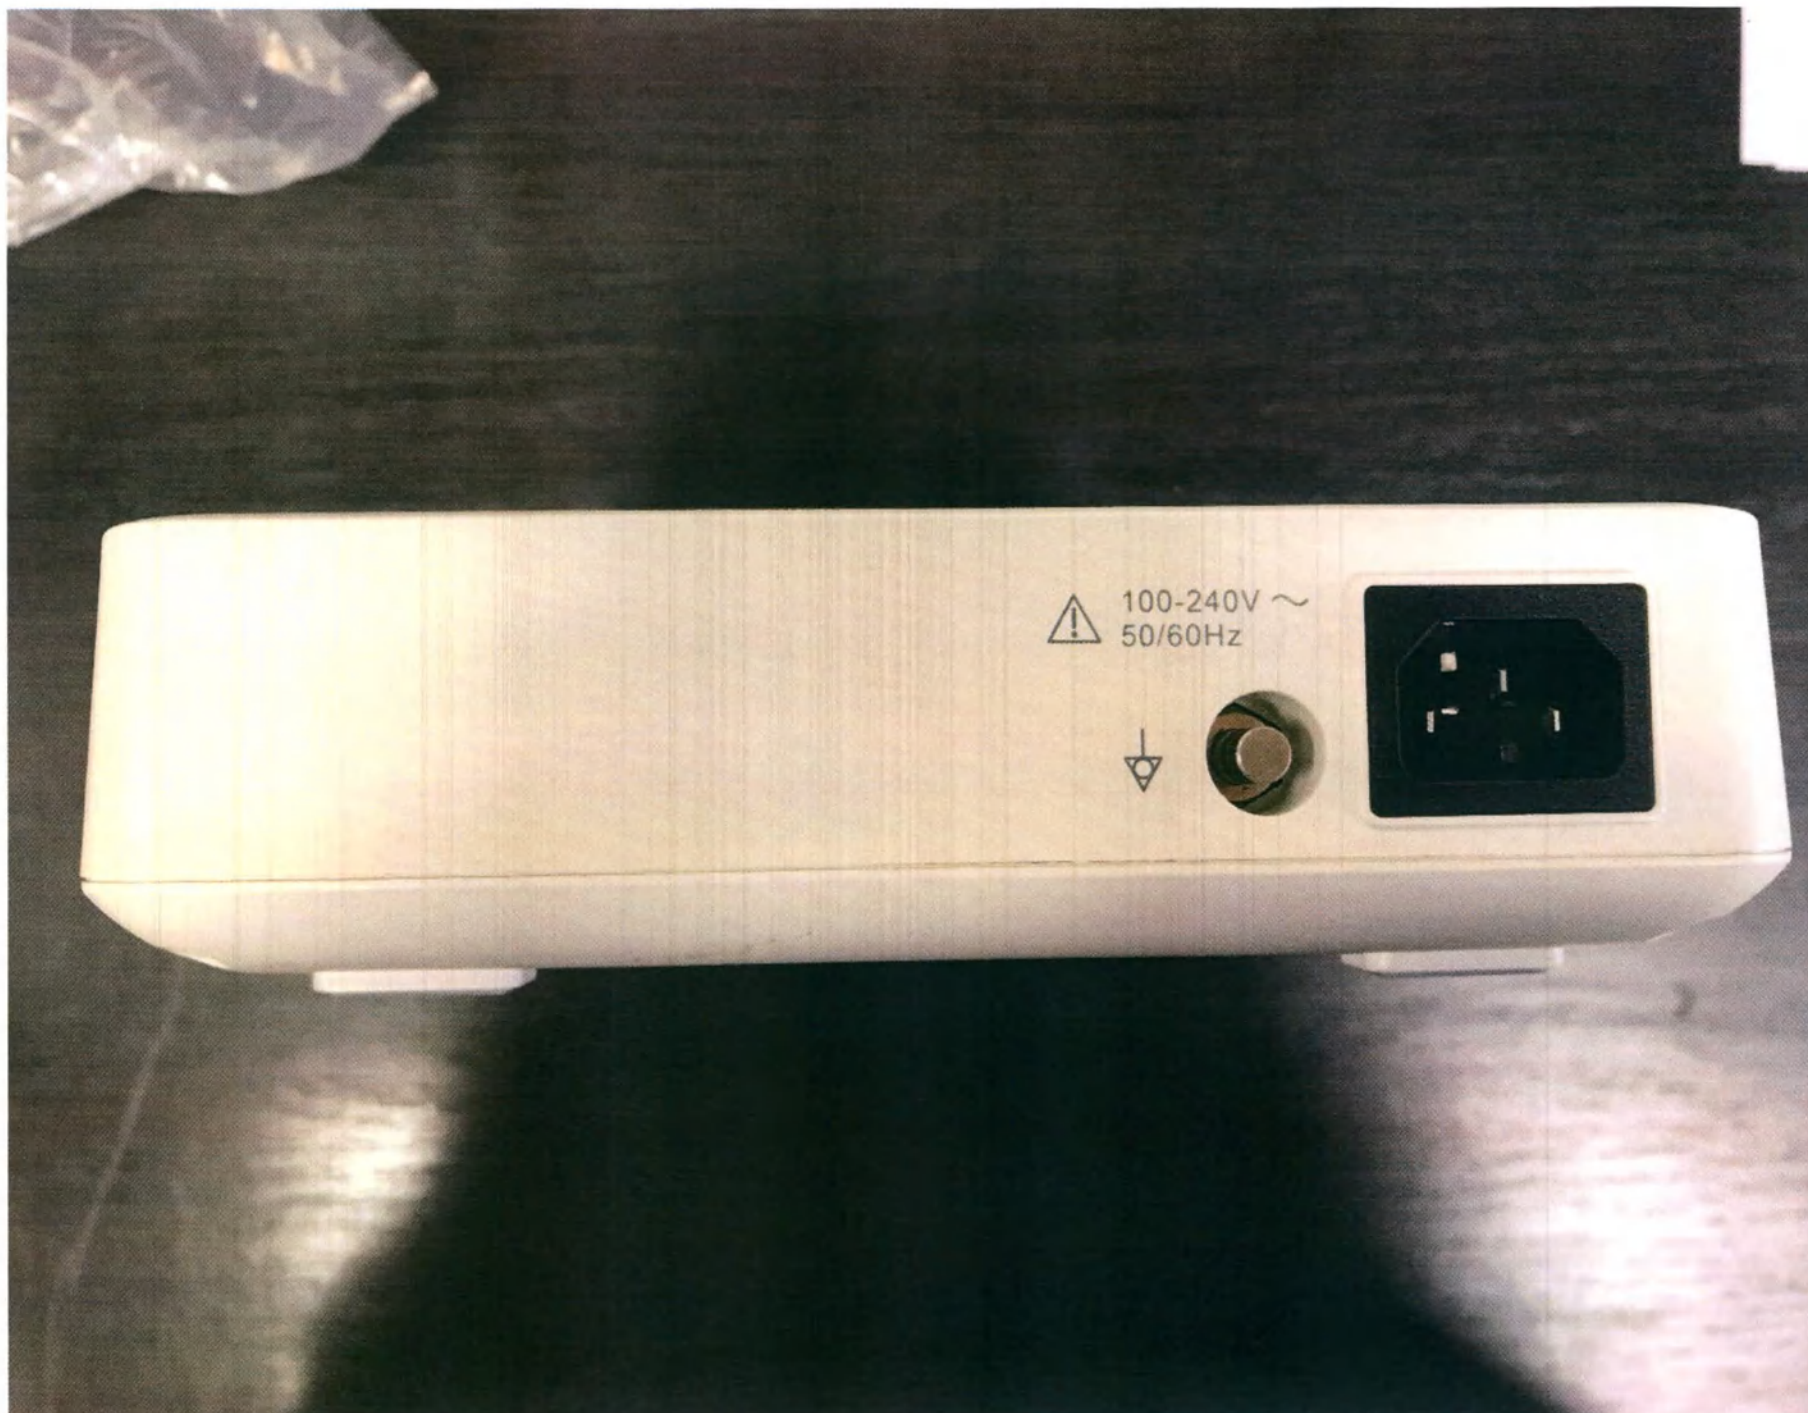

Блок базовый НЗ (вид сбоку)

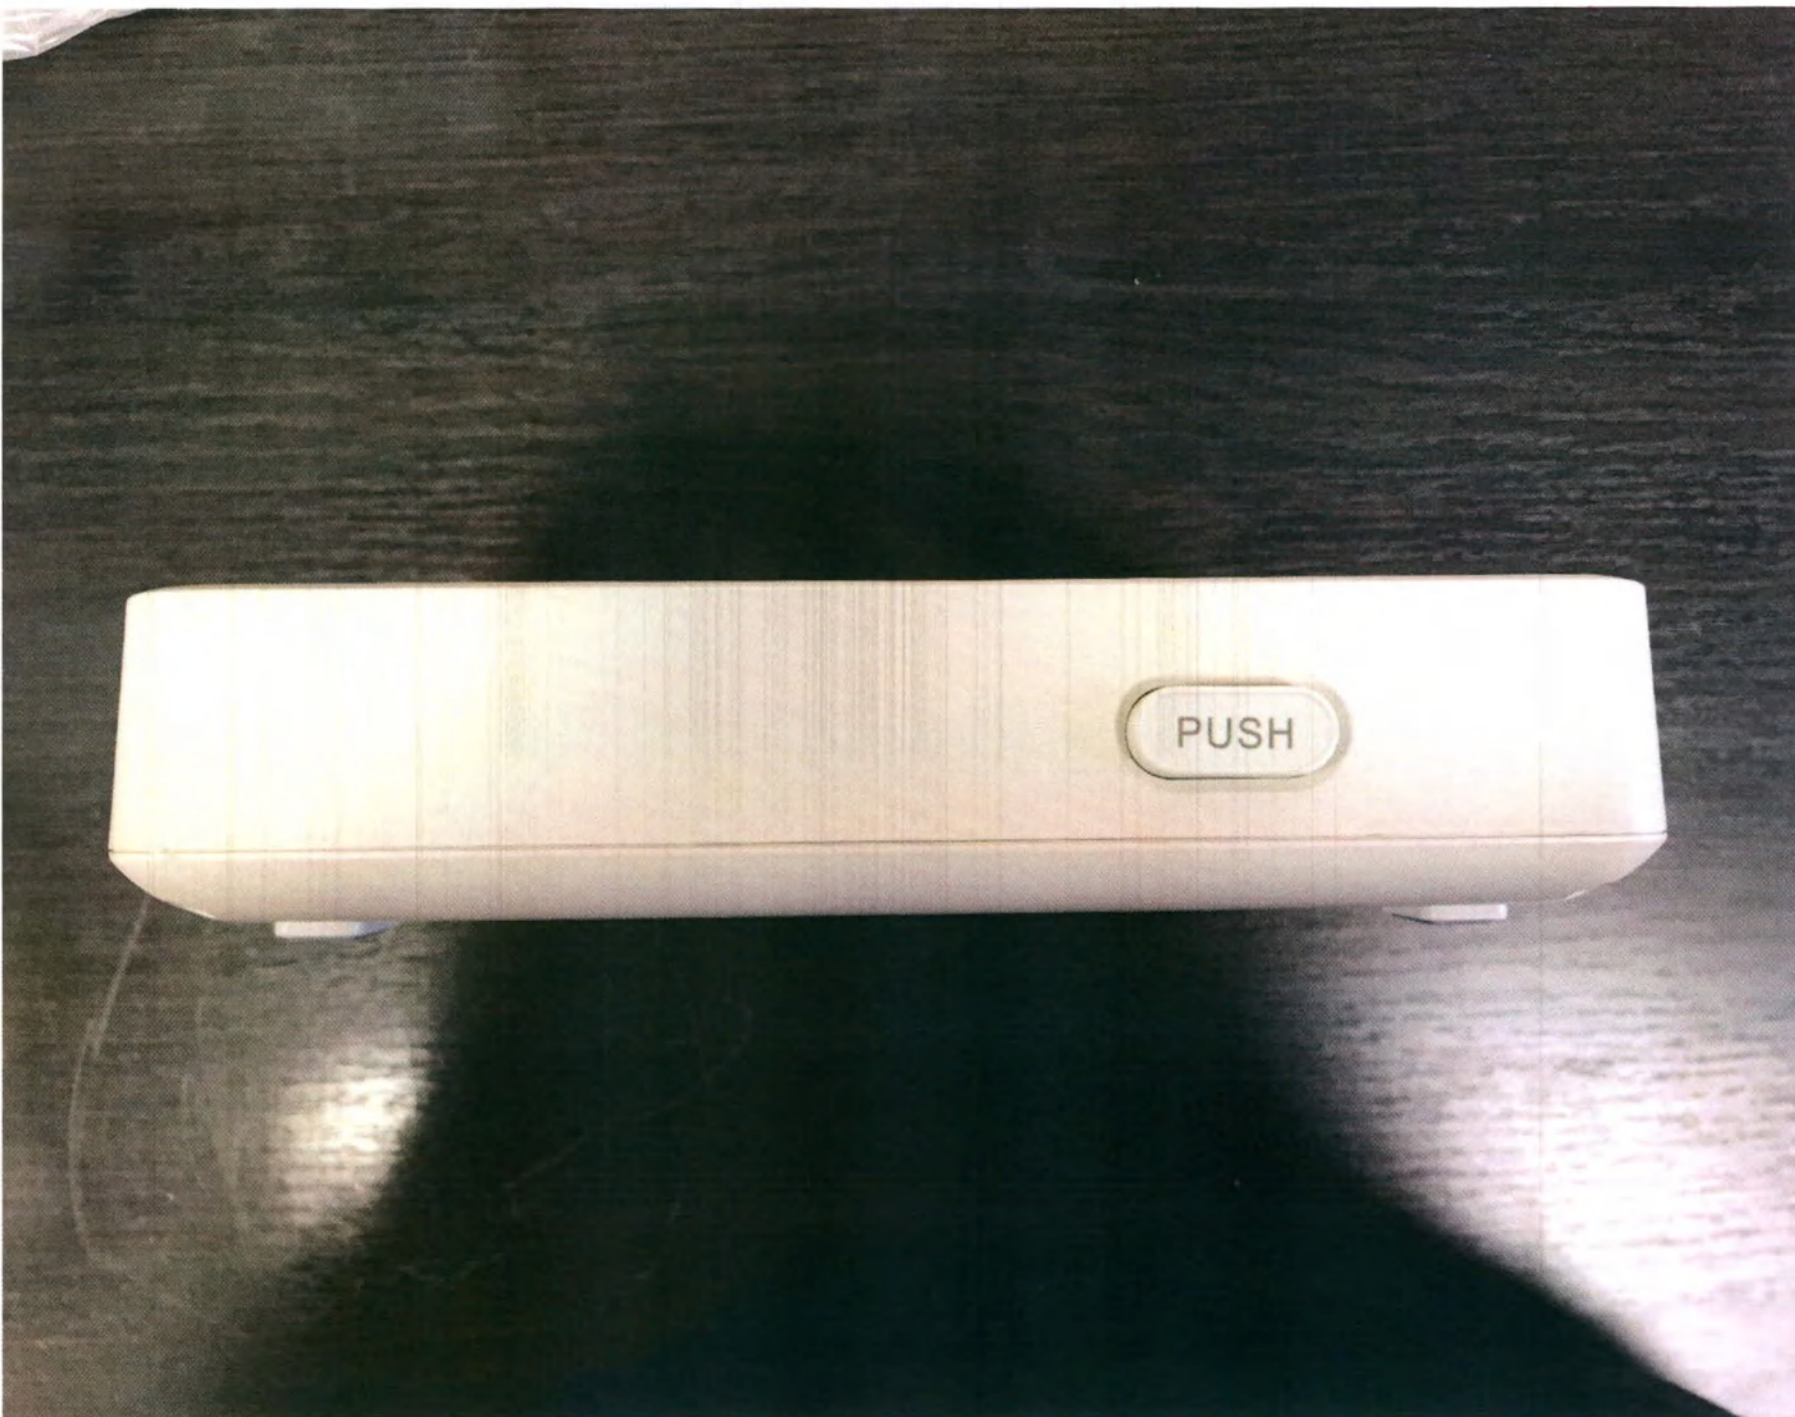

Блок базовый НЗ (вид сбоку)



Блок базовый H3 (вид снизу, задняя панель)

SN


H3220830002

COMEN

30.08.2022



Электрокардиограф НЗ

Номинальное напряжение: 100–240В~Номинальная частота: 50/60ГцНоминальная мощность: 40ВА

IPX0

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5
of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,
Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика


Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть
помещ. 6Н С НОМ 39.49




Кабель заземления

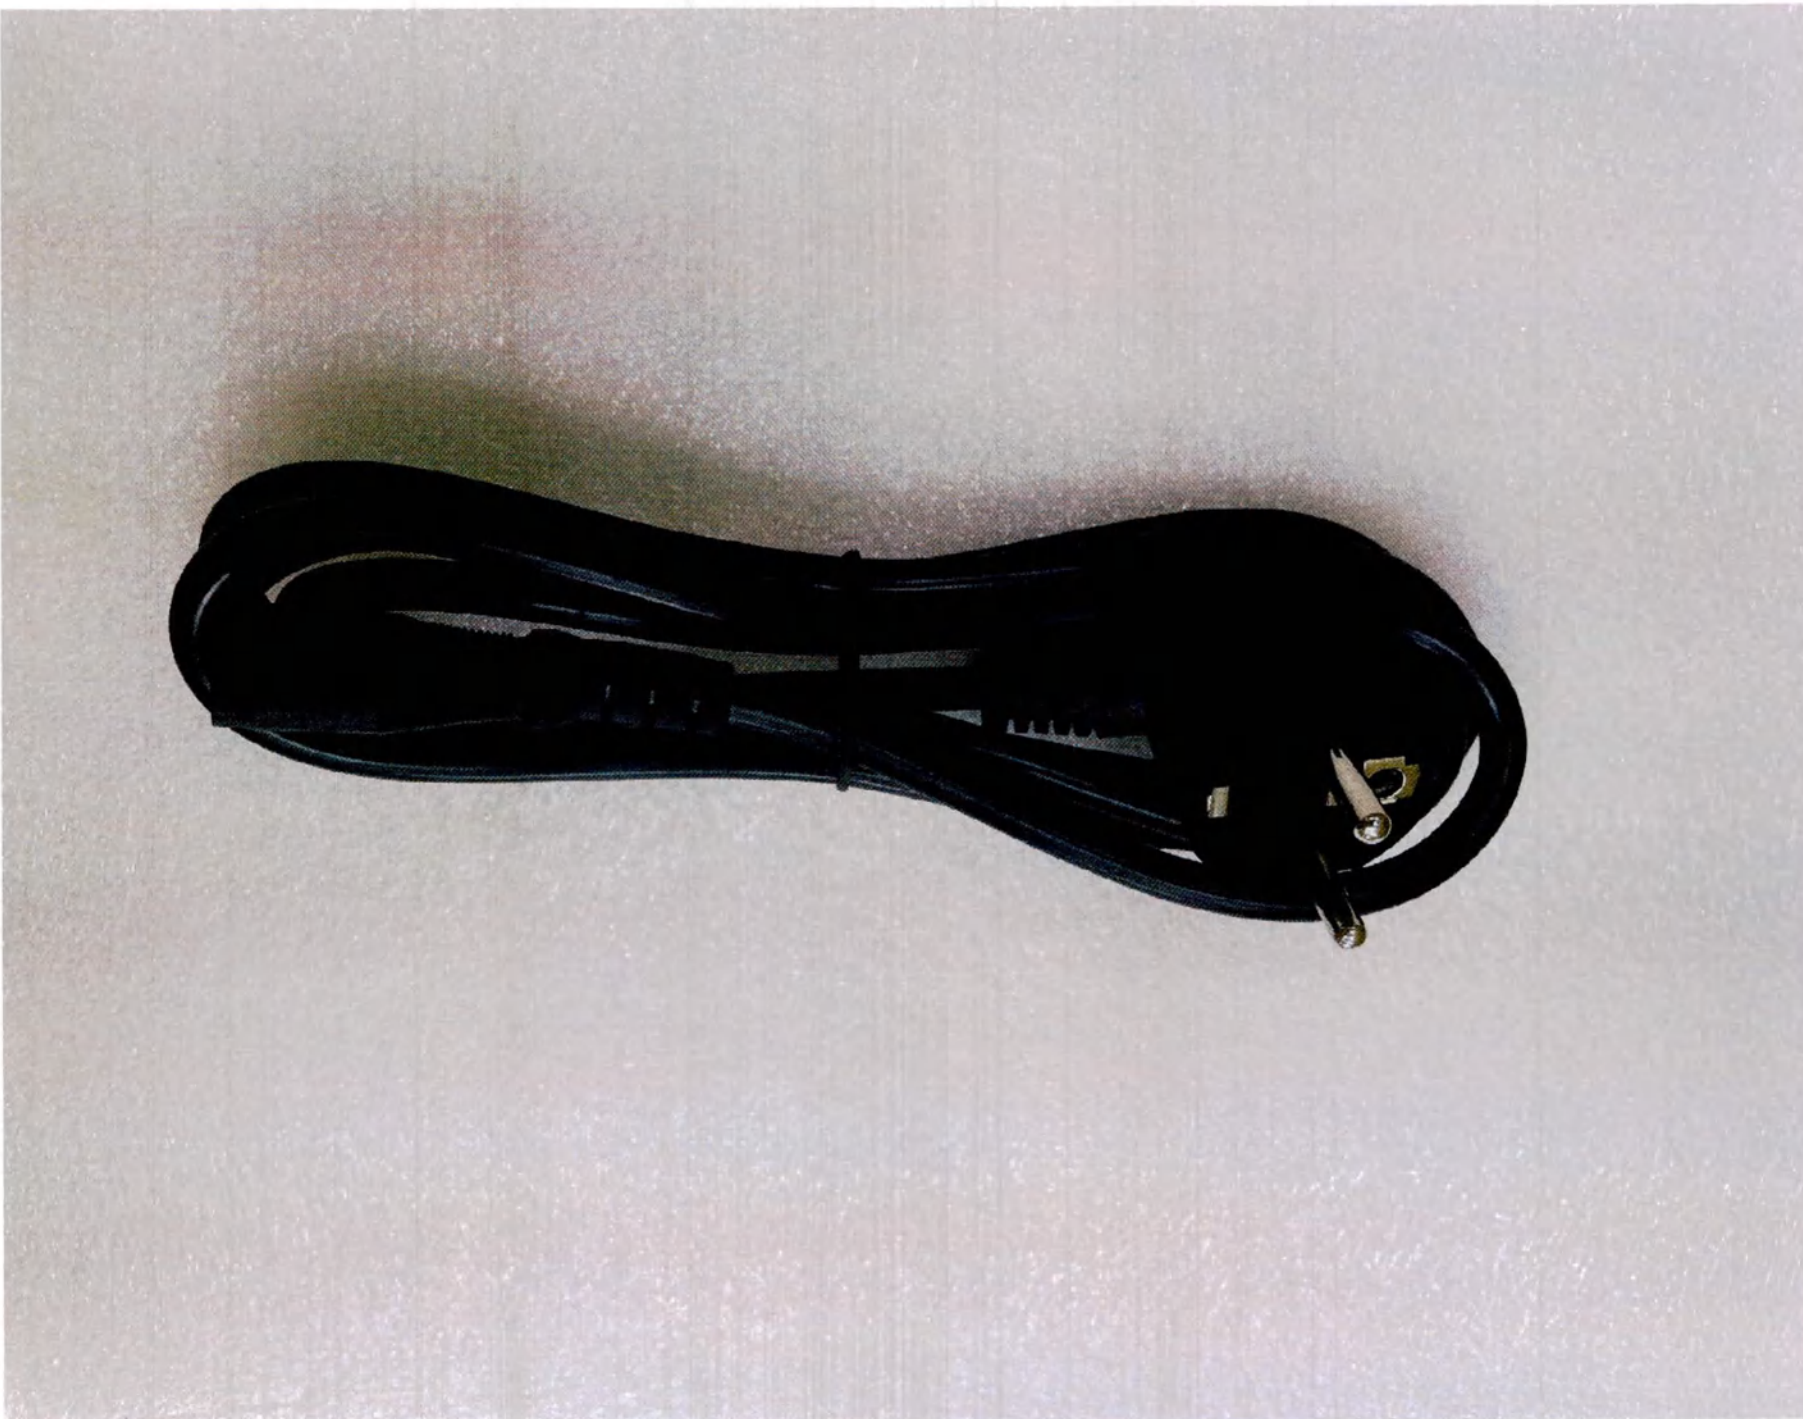

Кабель питания

Revision 1 / Редакция 1

	«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ» Director General / Генеральный директор Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./ Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.  Yi Yong (И Юн) « 02 » 03 2023 г. Stamp/печать
--	---

USER MANUAL OF MEDICAL DEVICE/

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Electrocardiograph, in versions/
Электрокардиограф, в вариантах исполнения**

**Electrocardiograph H3/
Электрокардиограф H3**

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./
Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.





Кабель ЭКГ на 12 отведений: Пример индивидуальной упаковки

SN**20230303 0031****03.03.2023****COMEN****Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1**

Количество в упаковке – 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.


(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China


Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.


Регистрационное удостоверение №

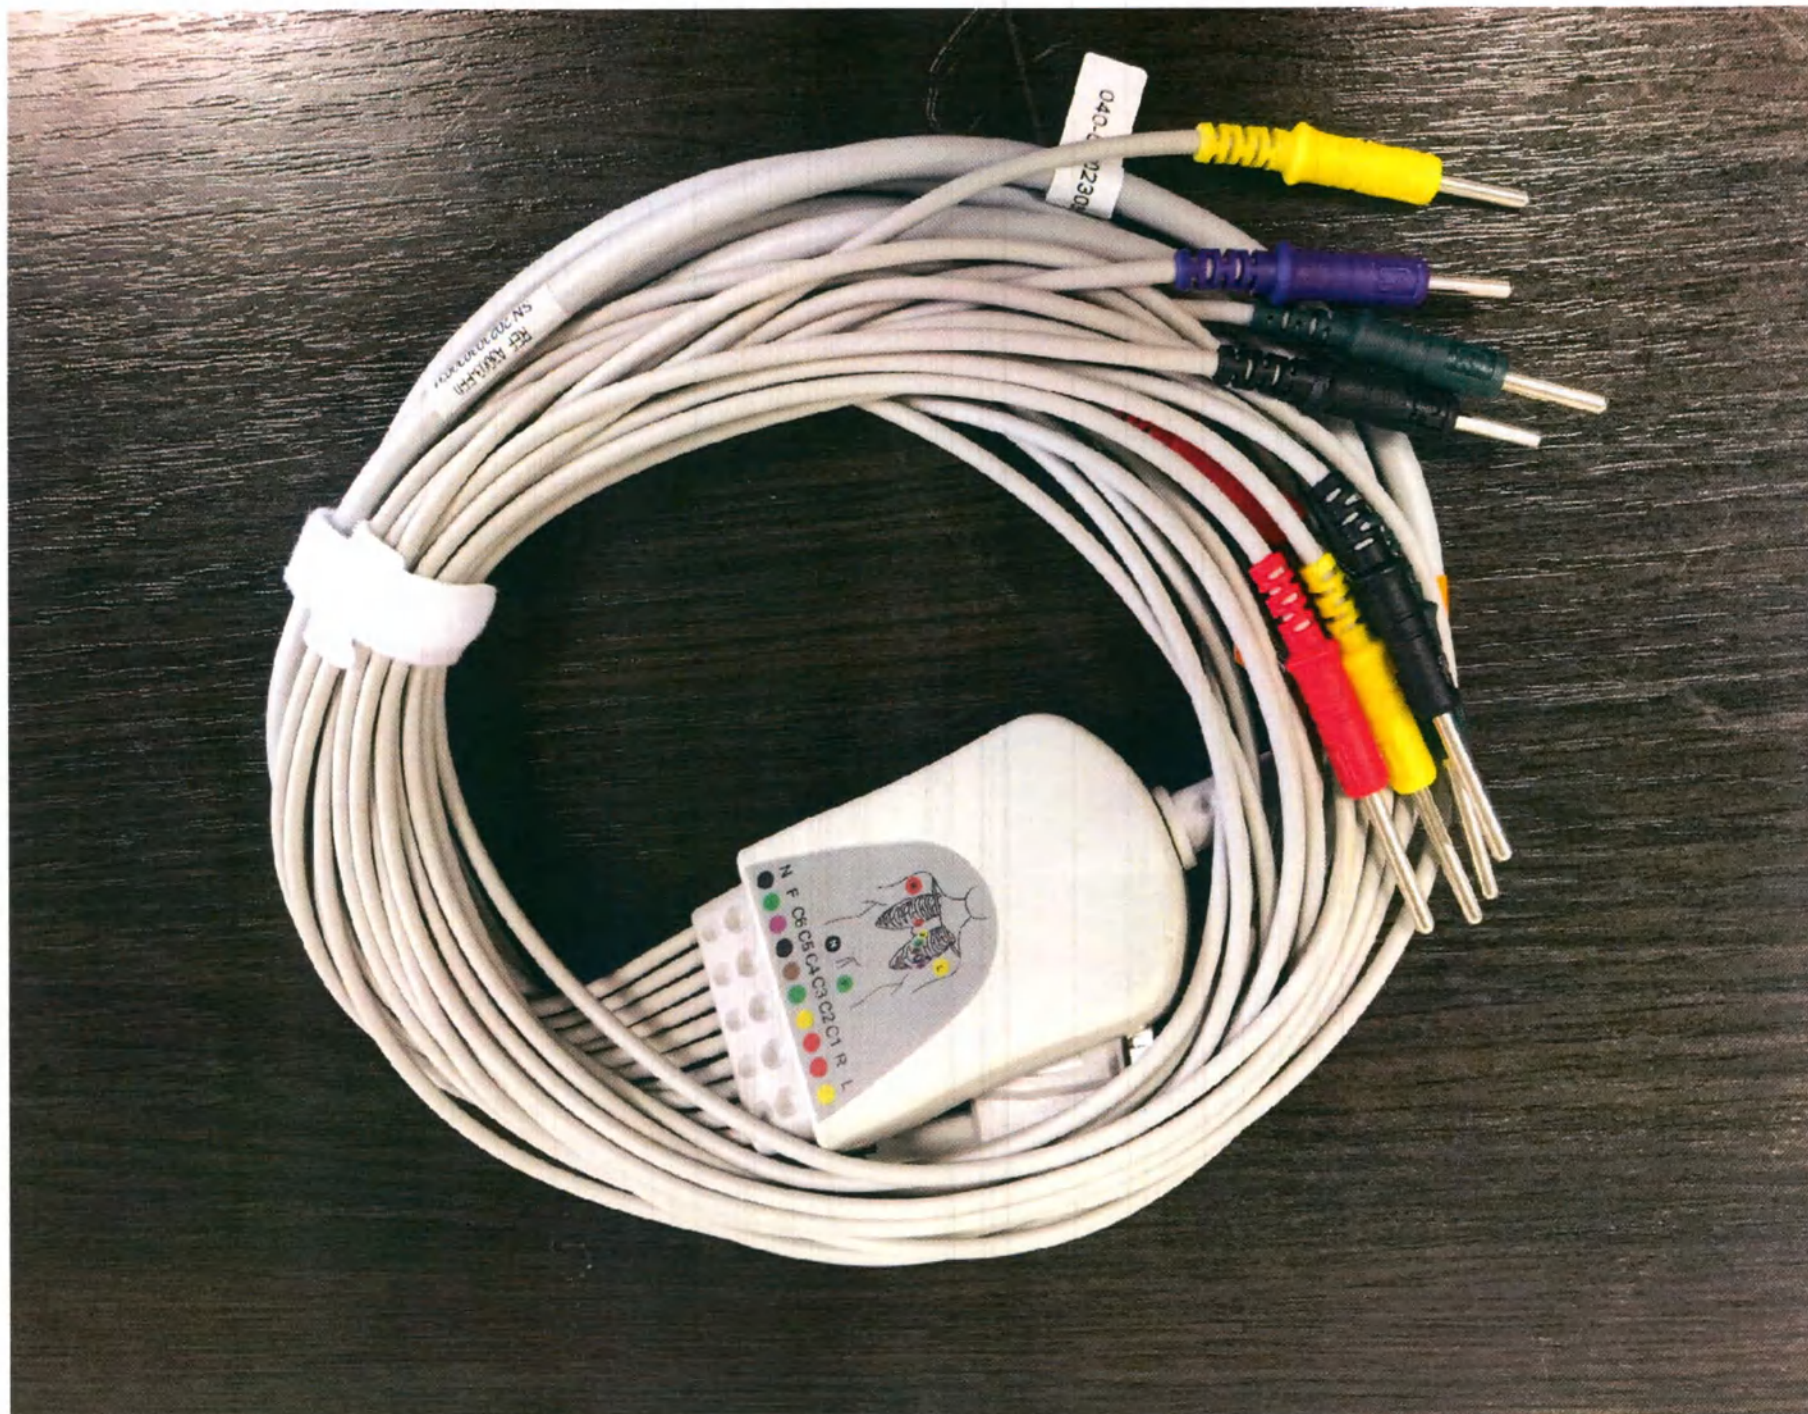

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (общий вид)

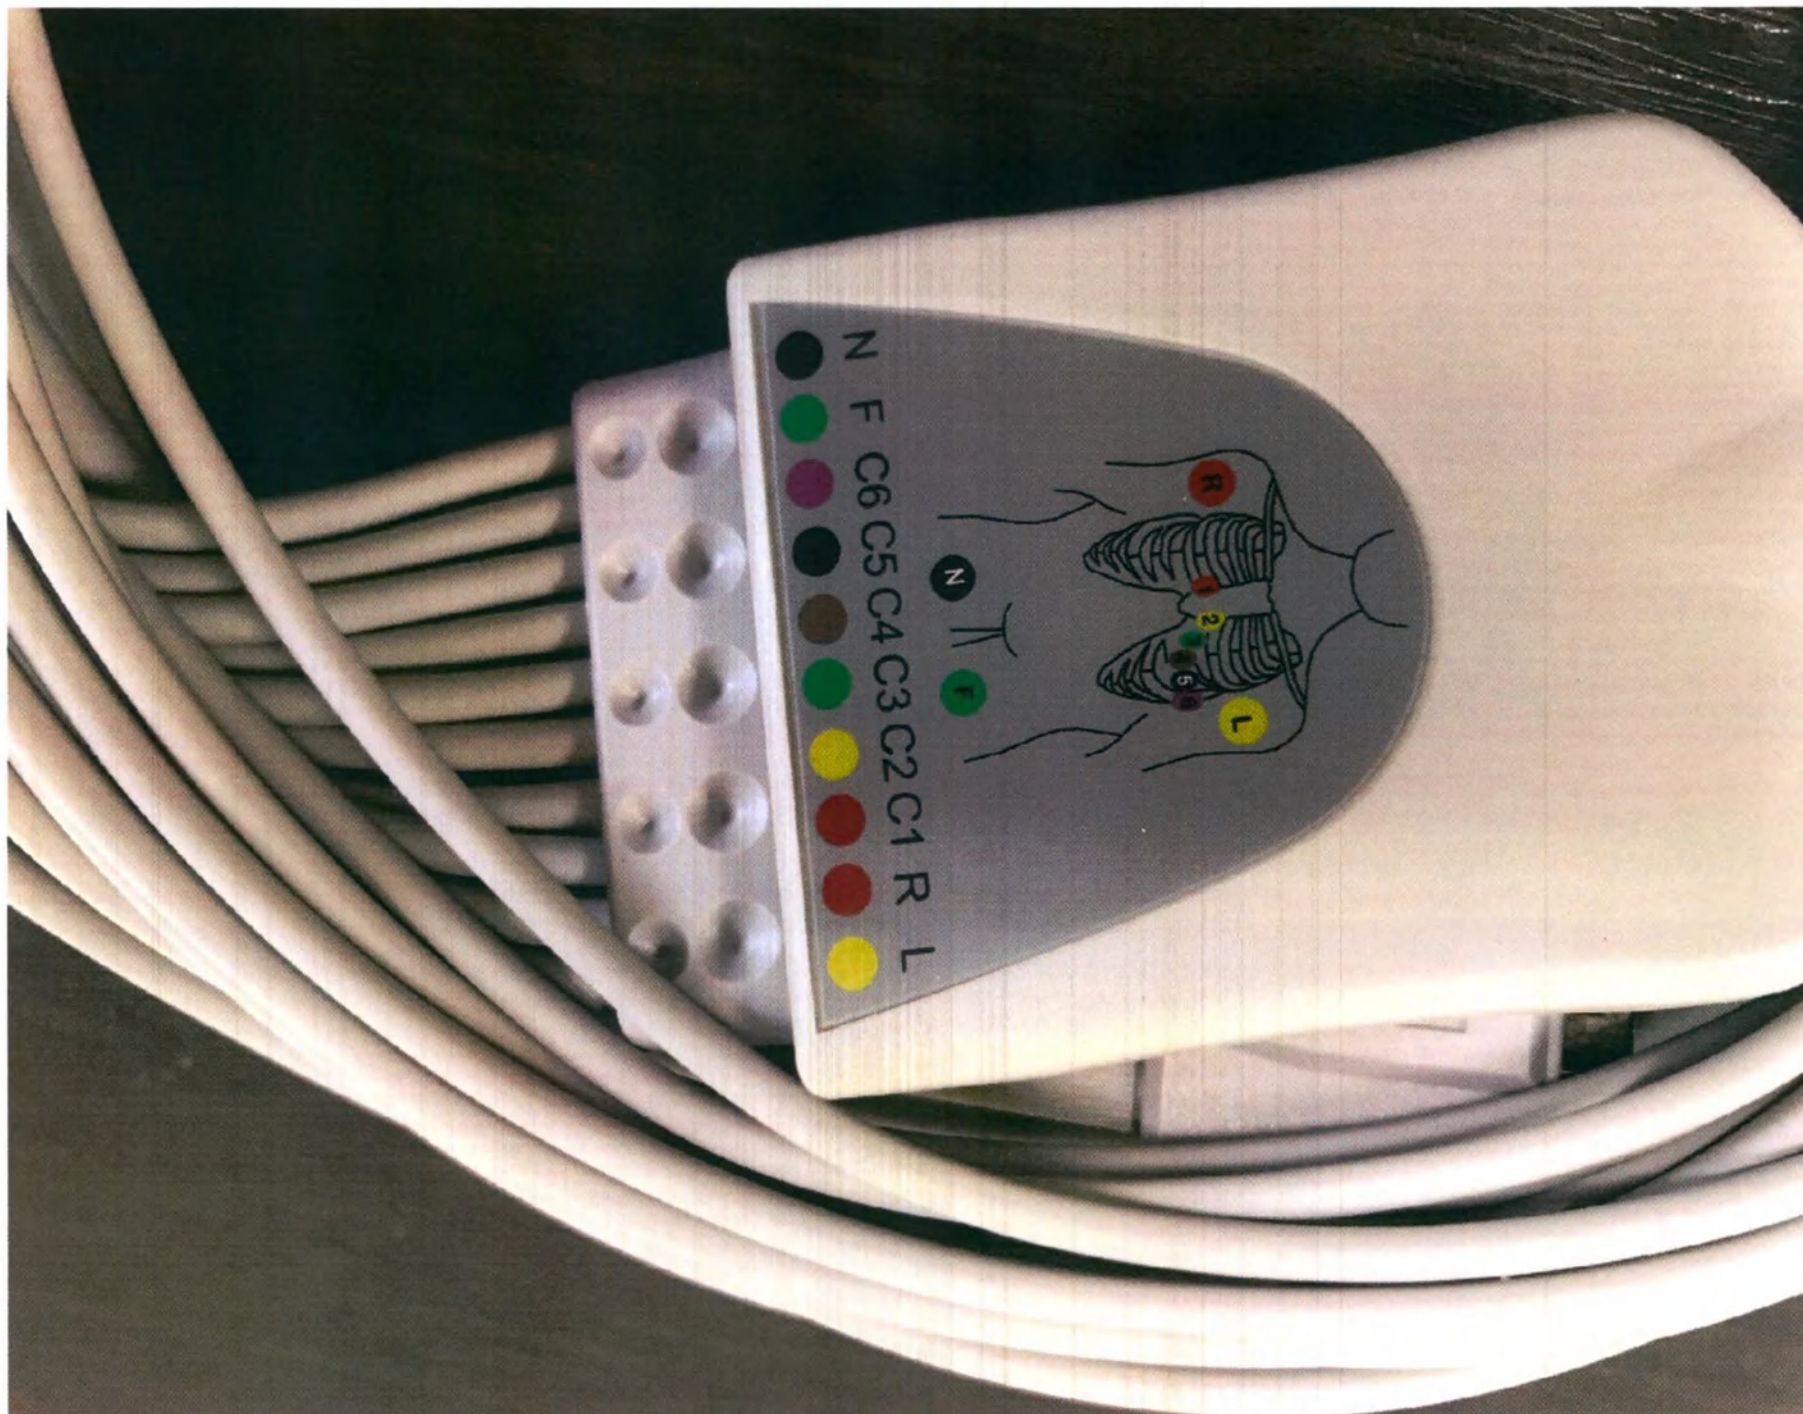


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (разъем отведений)

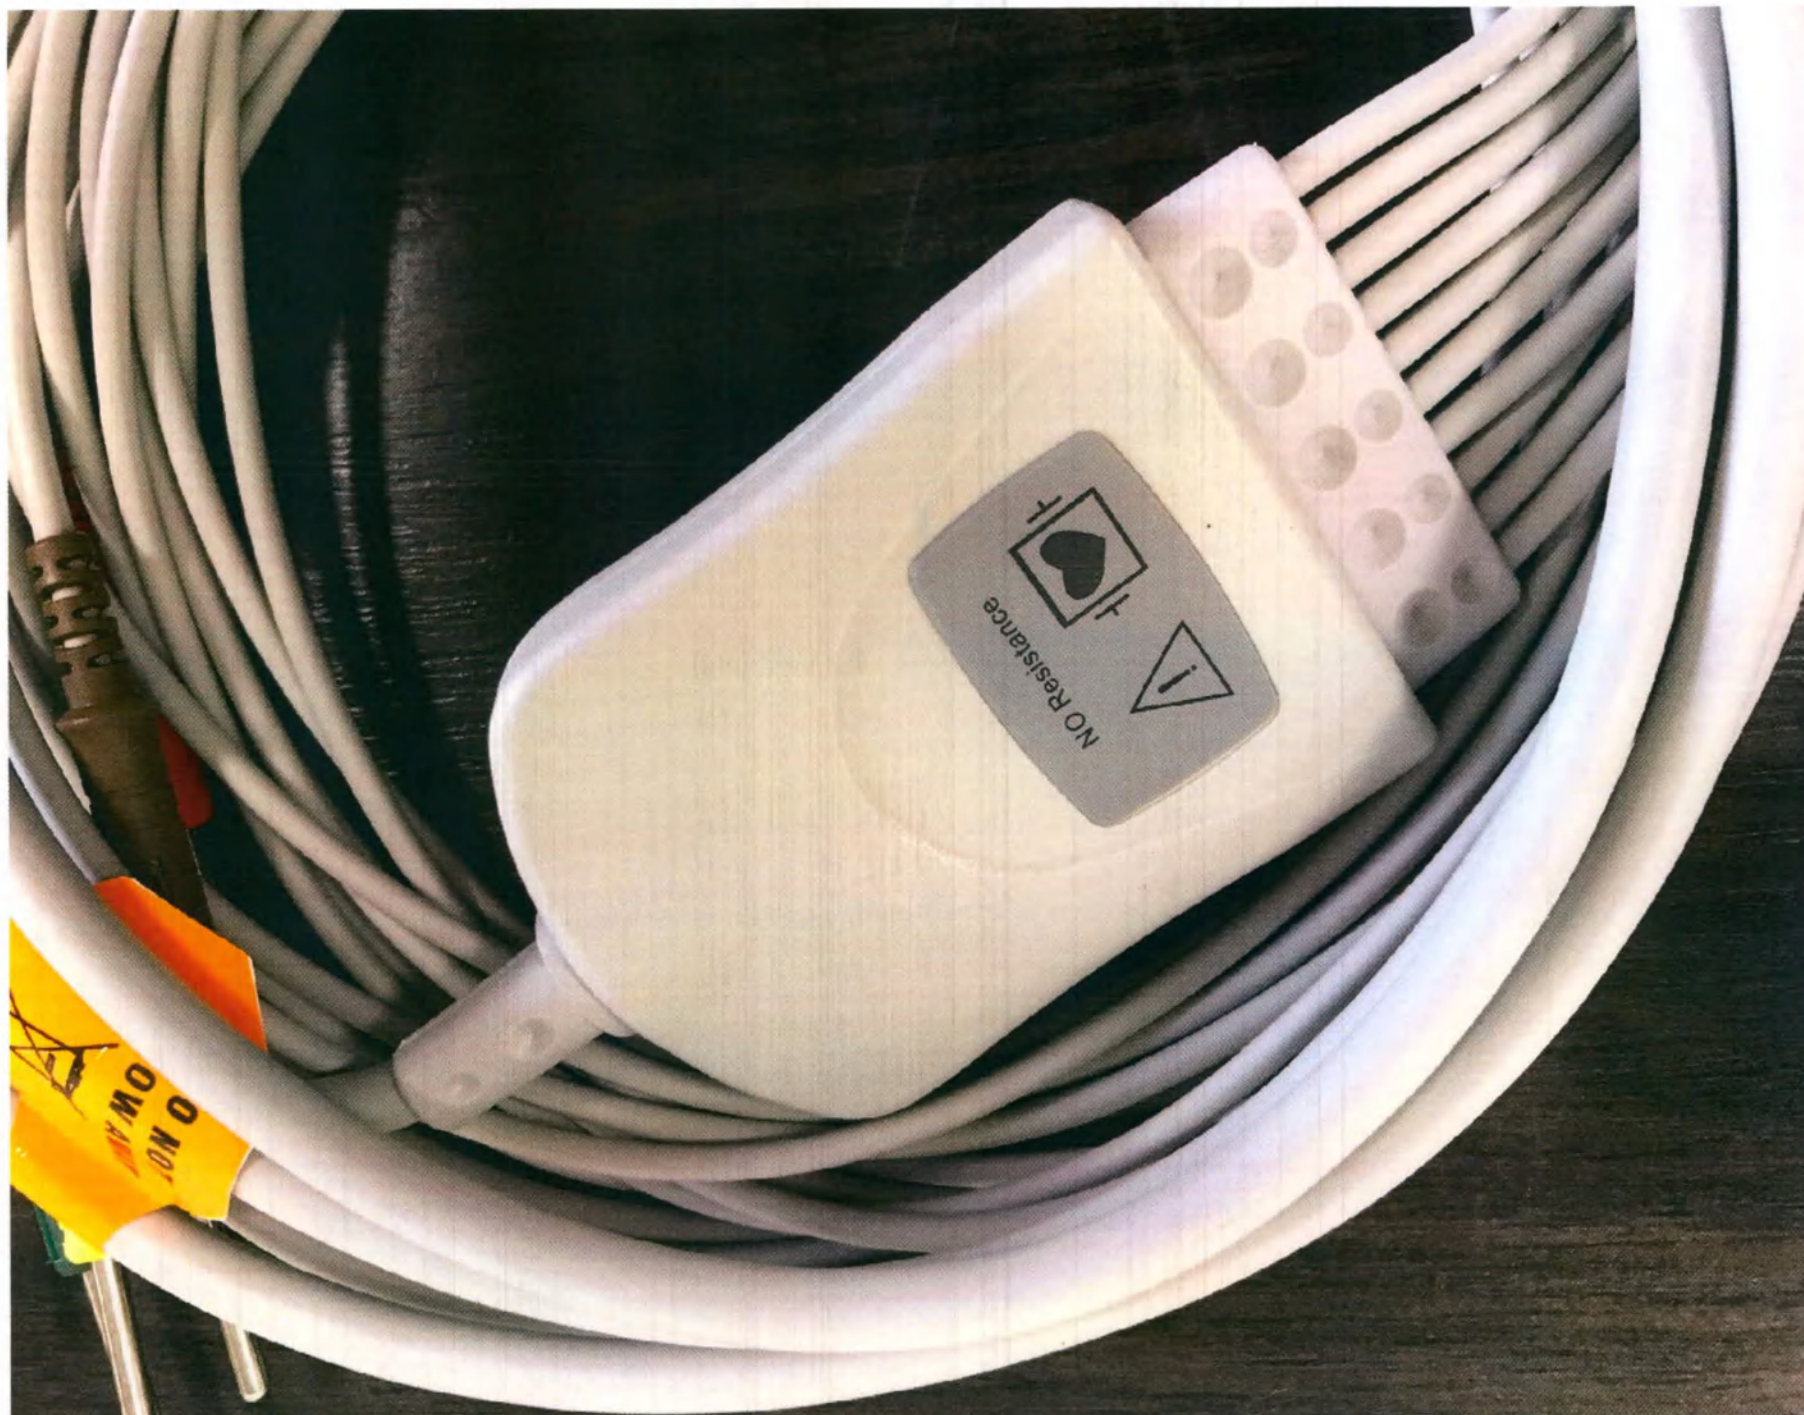


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (маркировка разъема отведений)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (наклейка с серийным номером)

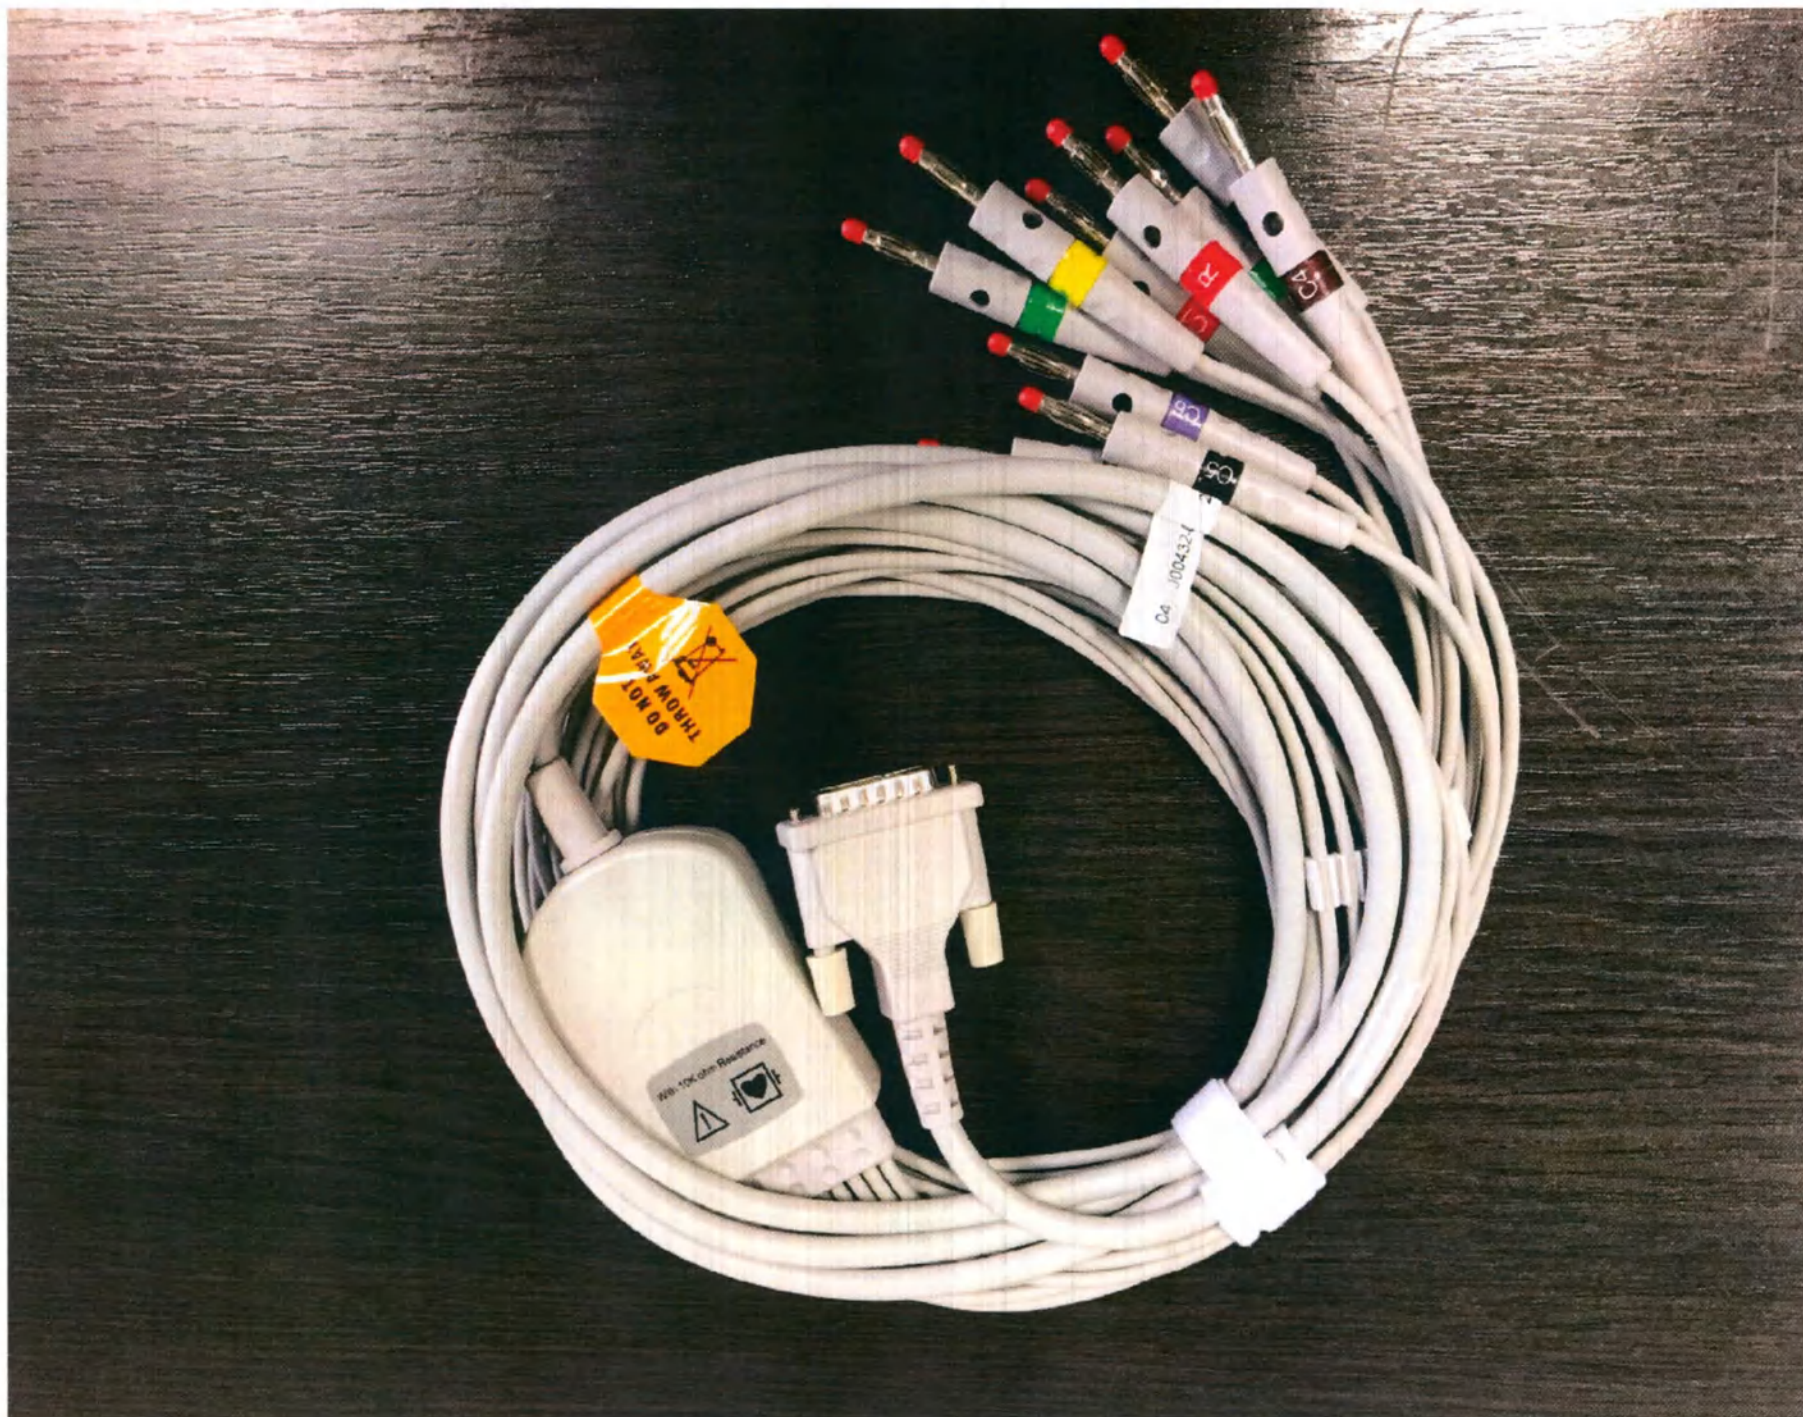


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (общий вид)

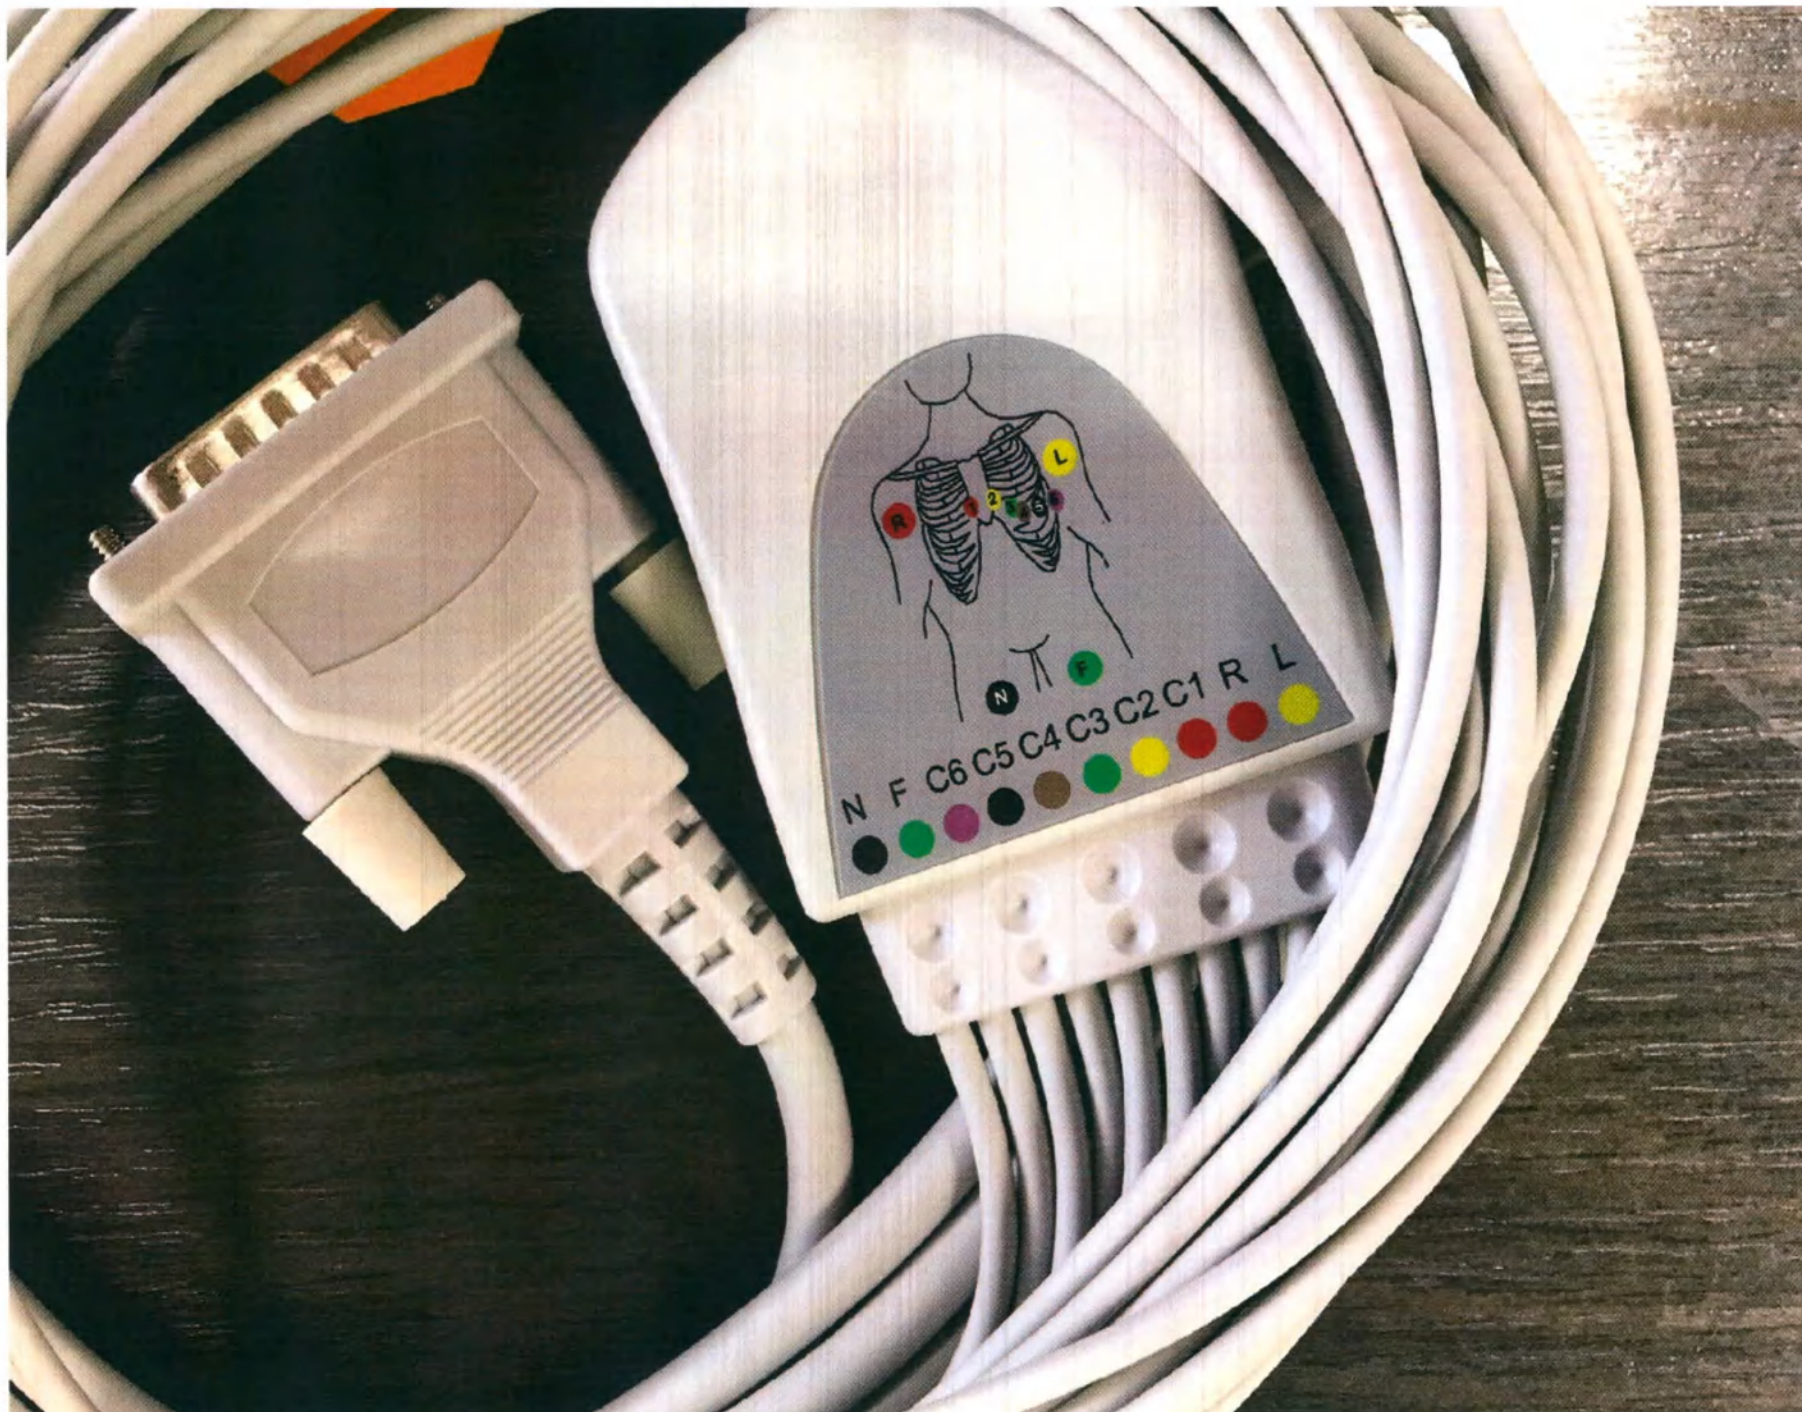


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений, маркировка)

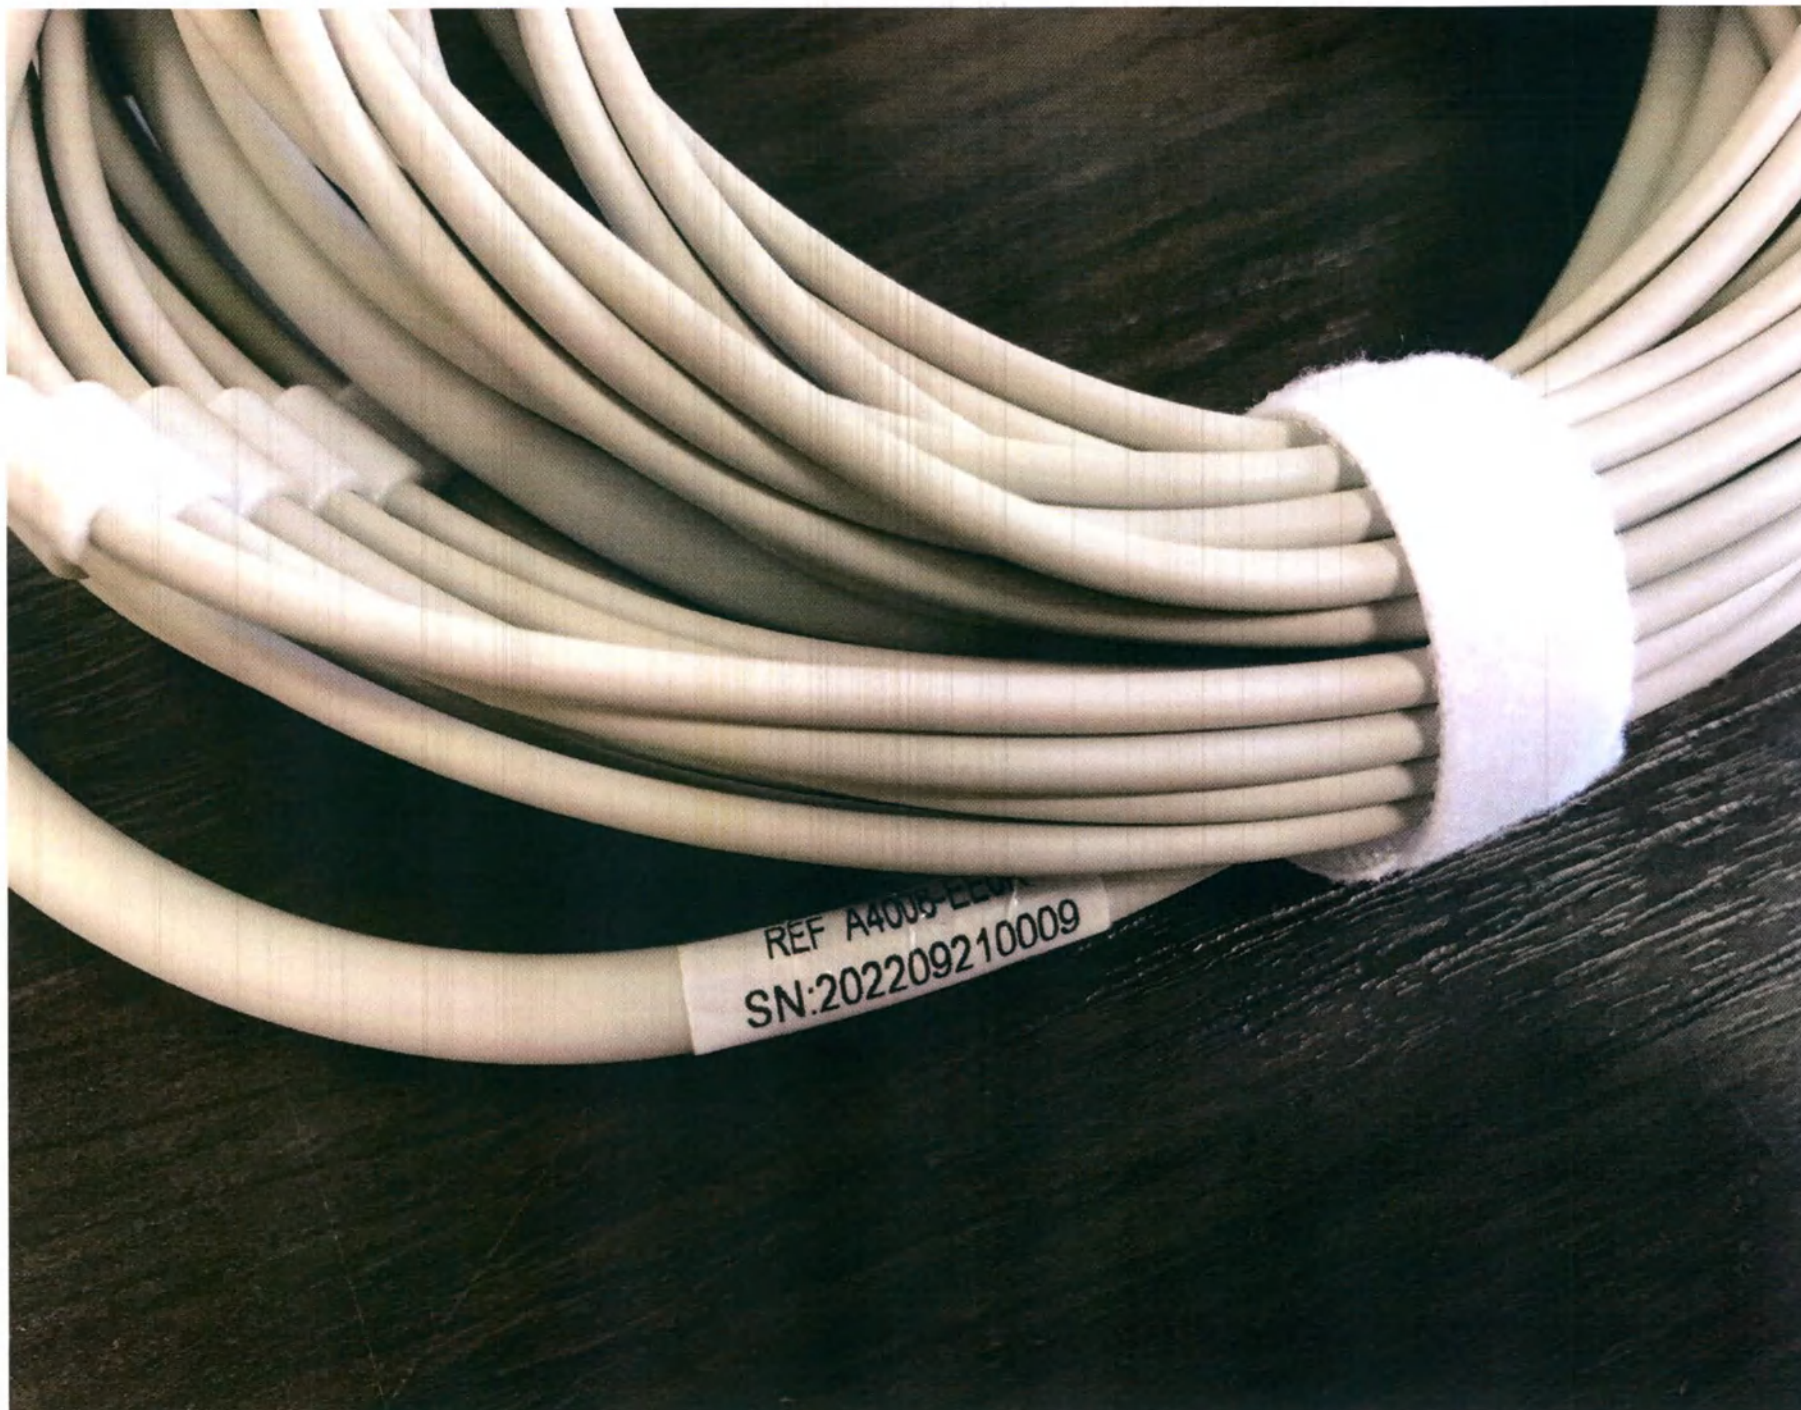


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (наклейка с серийным номером)

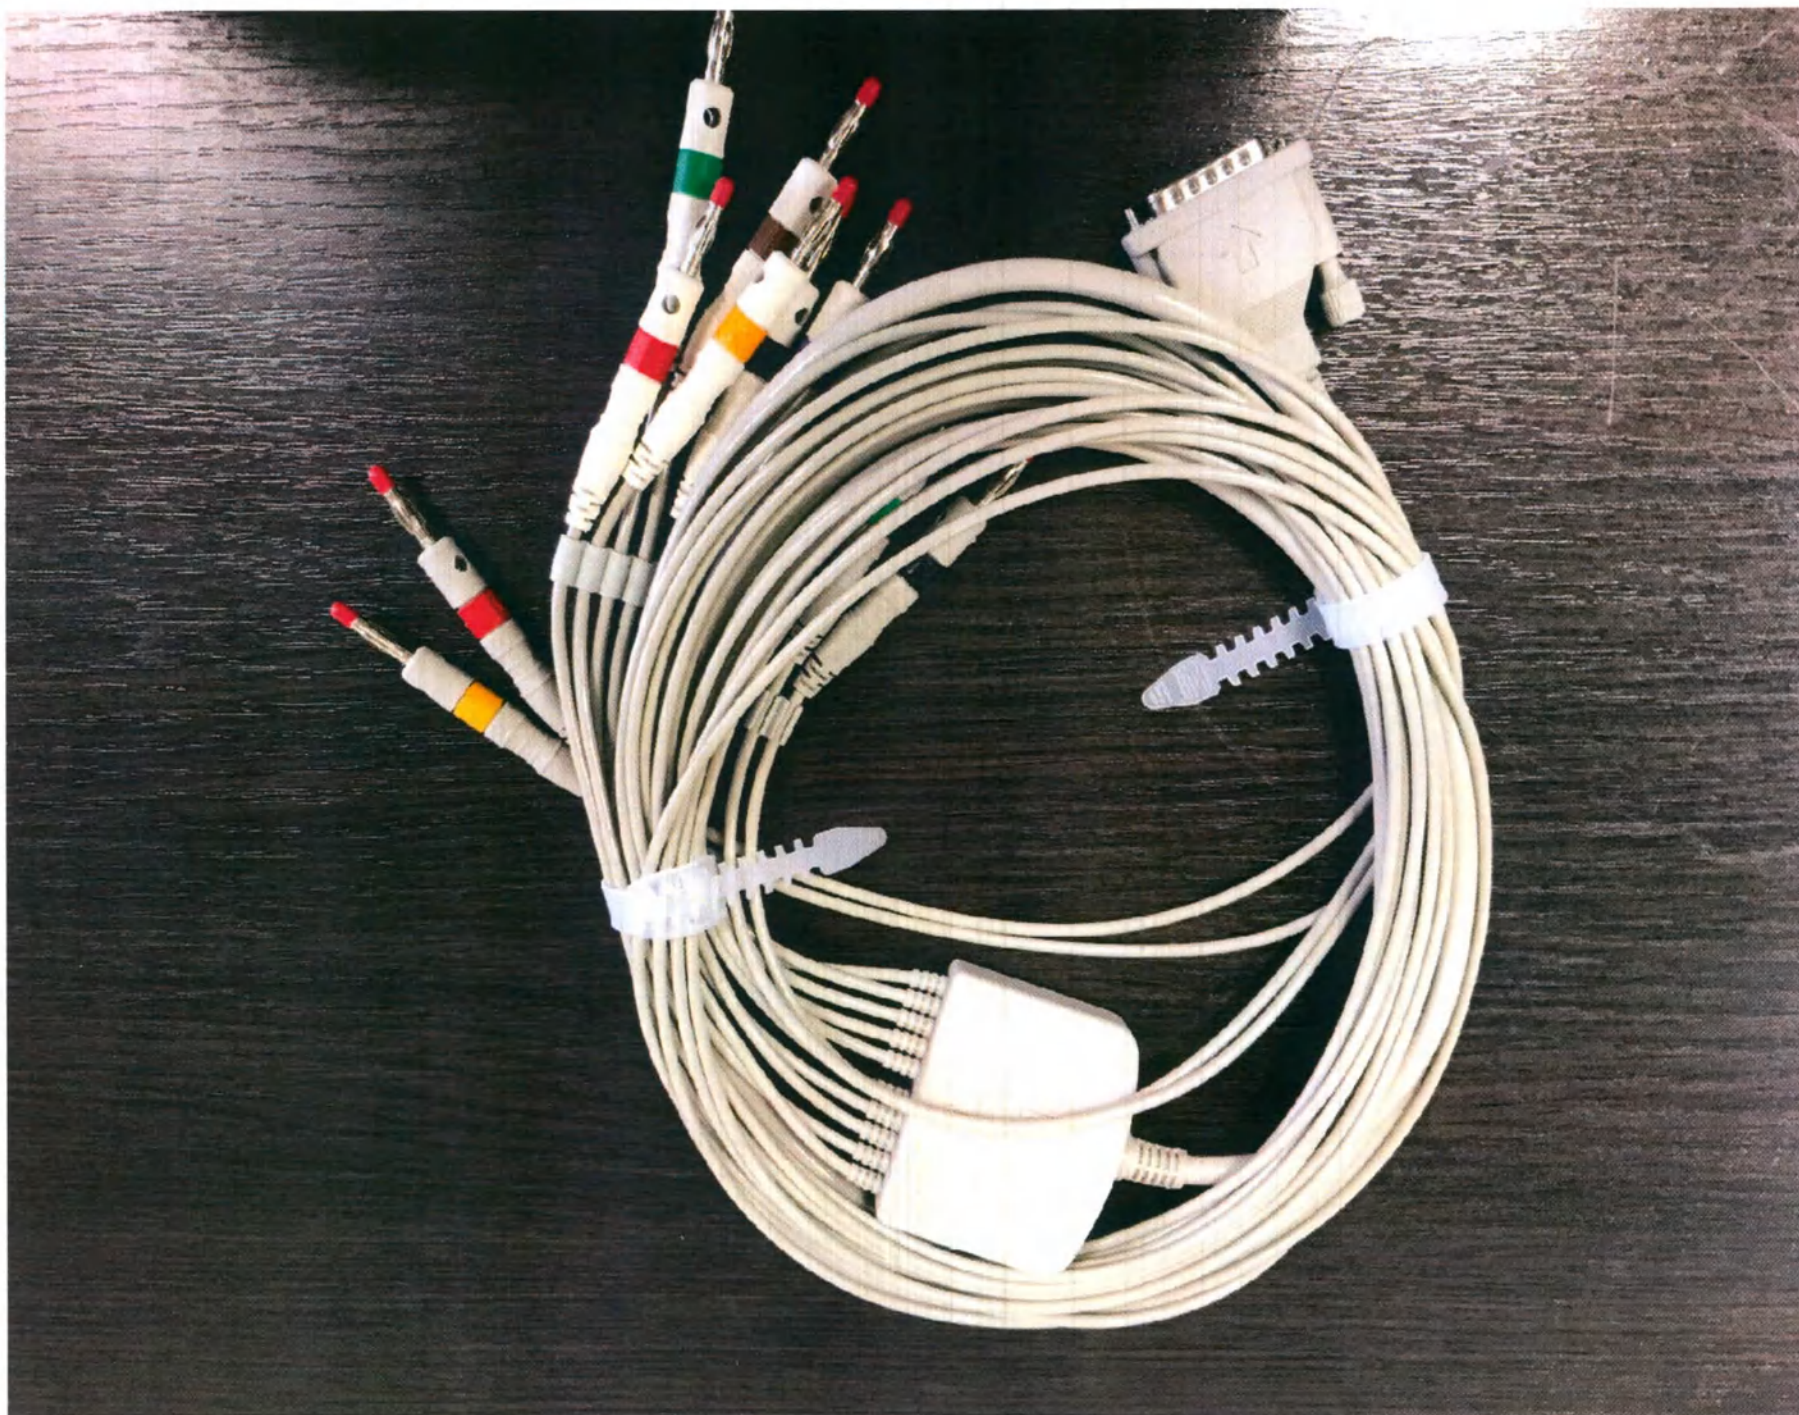

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (общий вид))

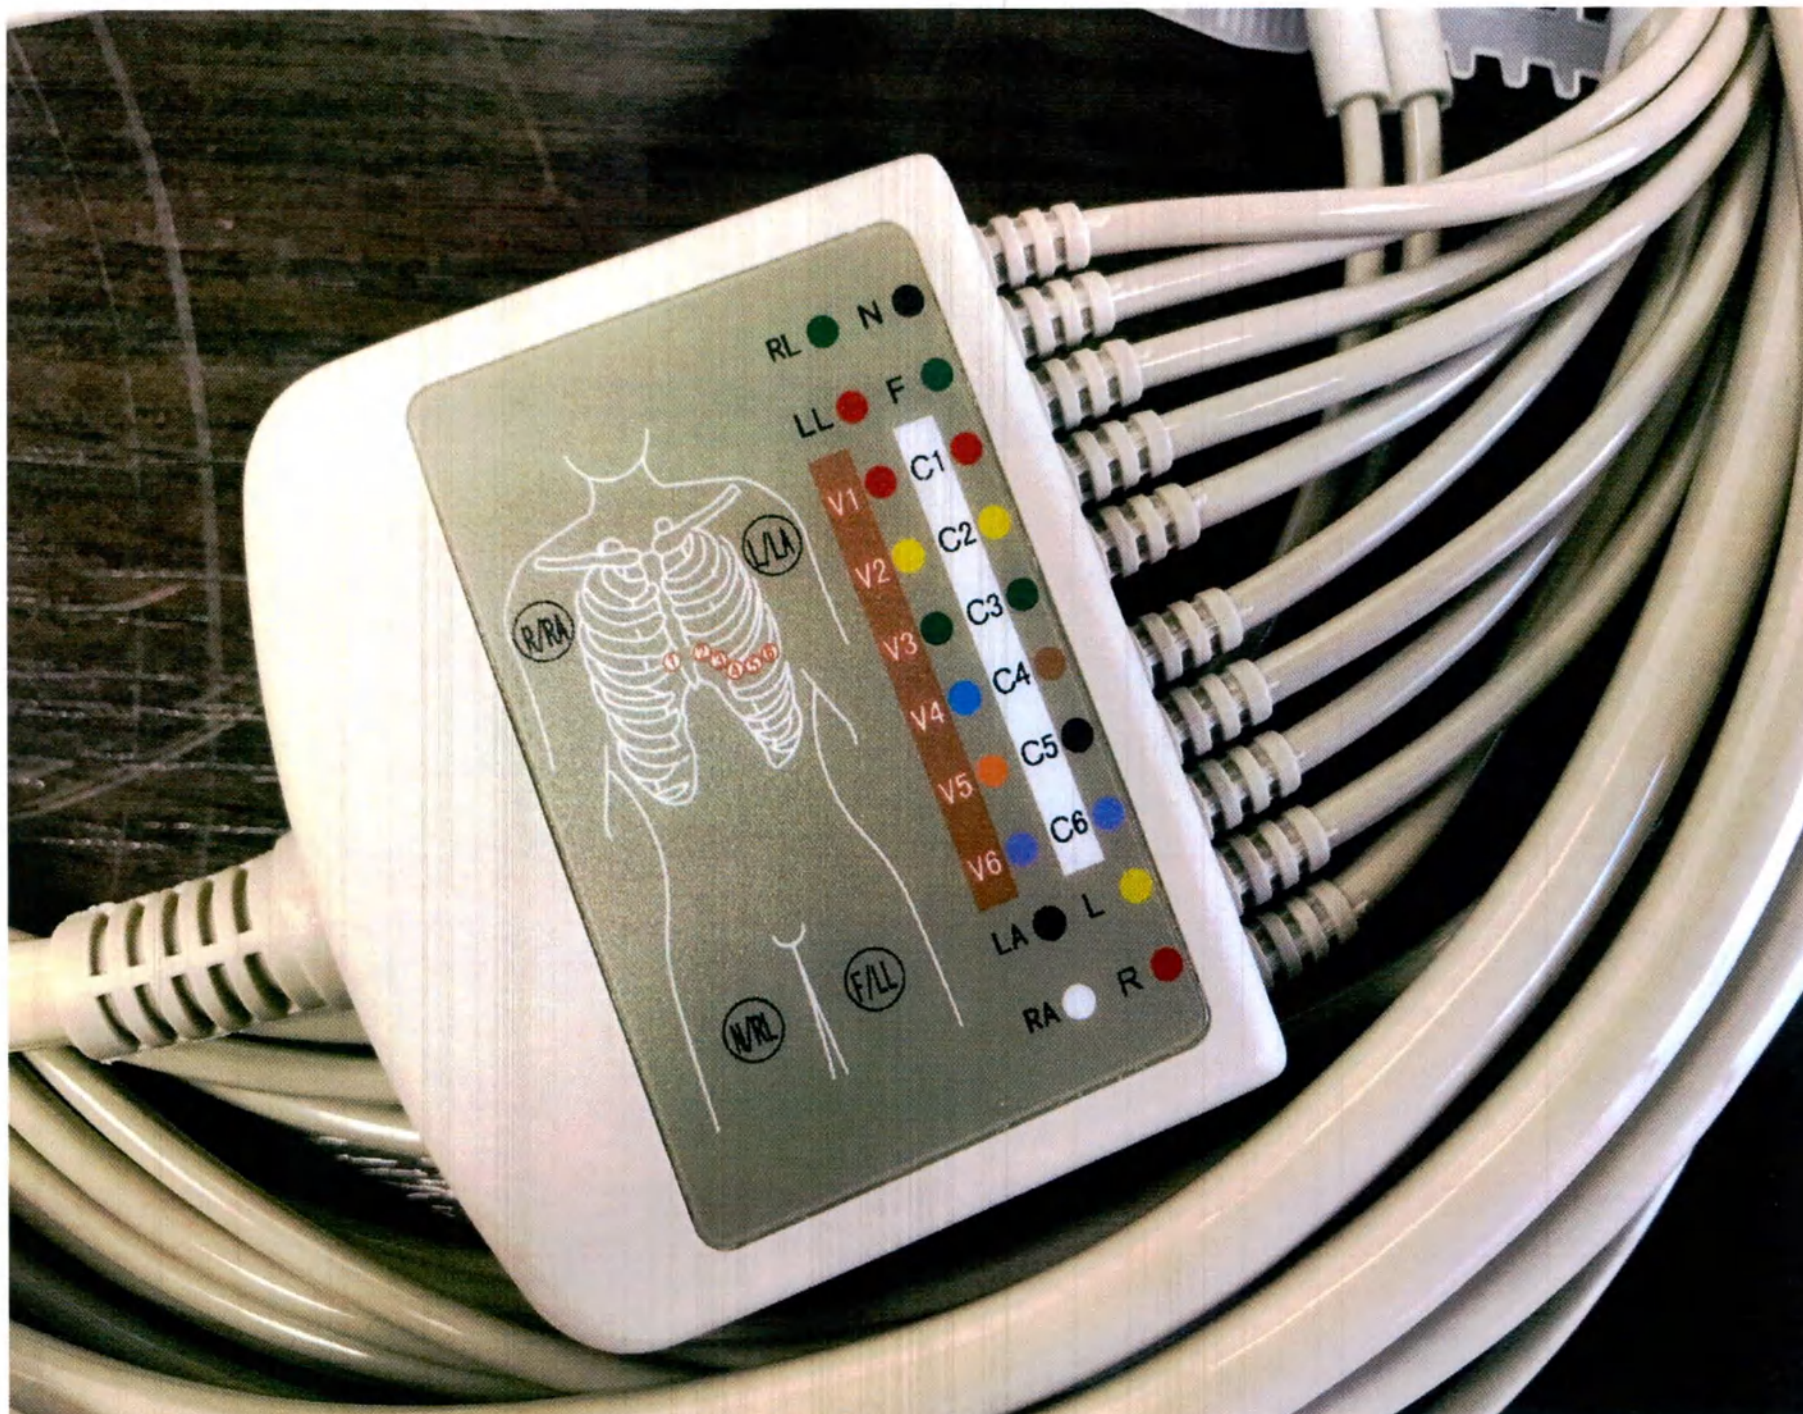


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (разъем отведений)

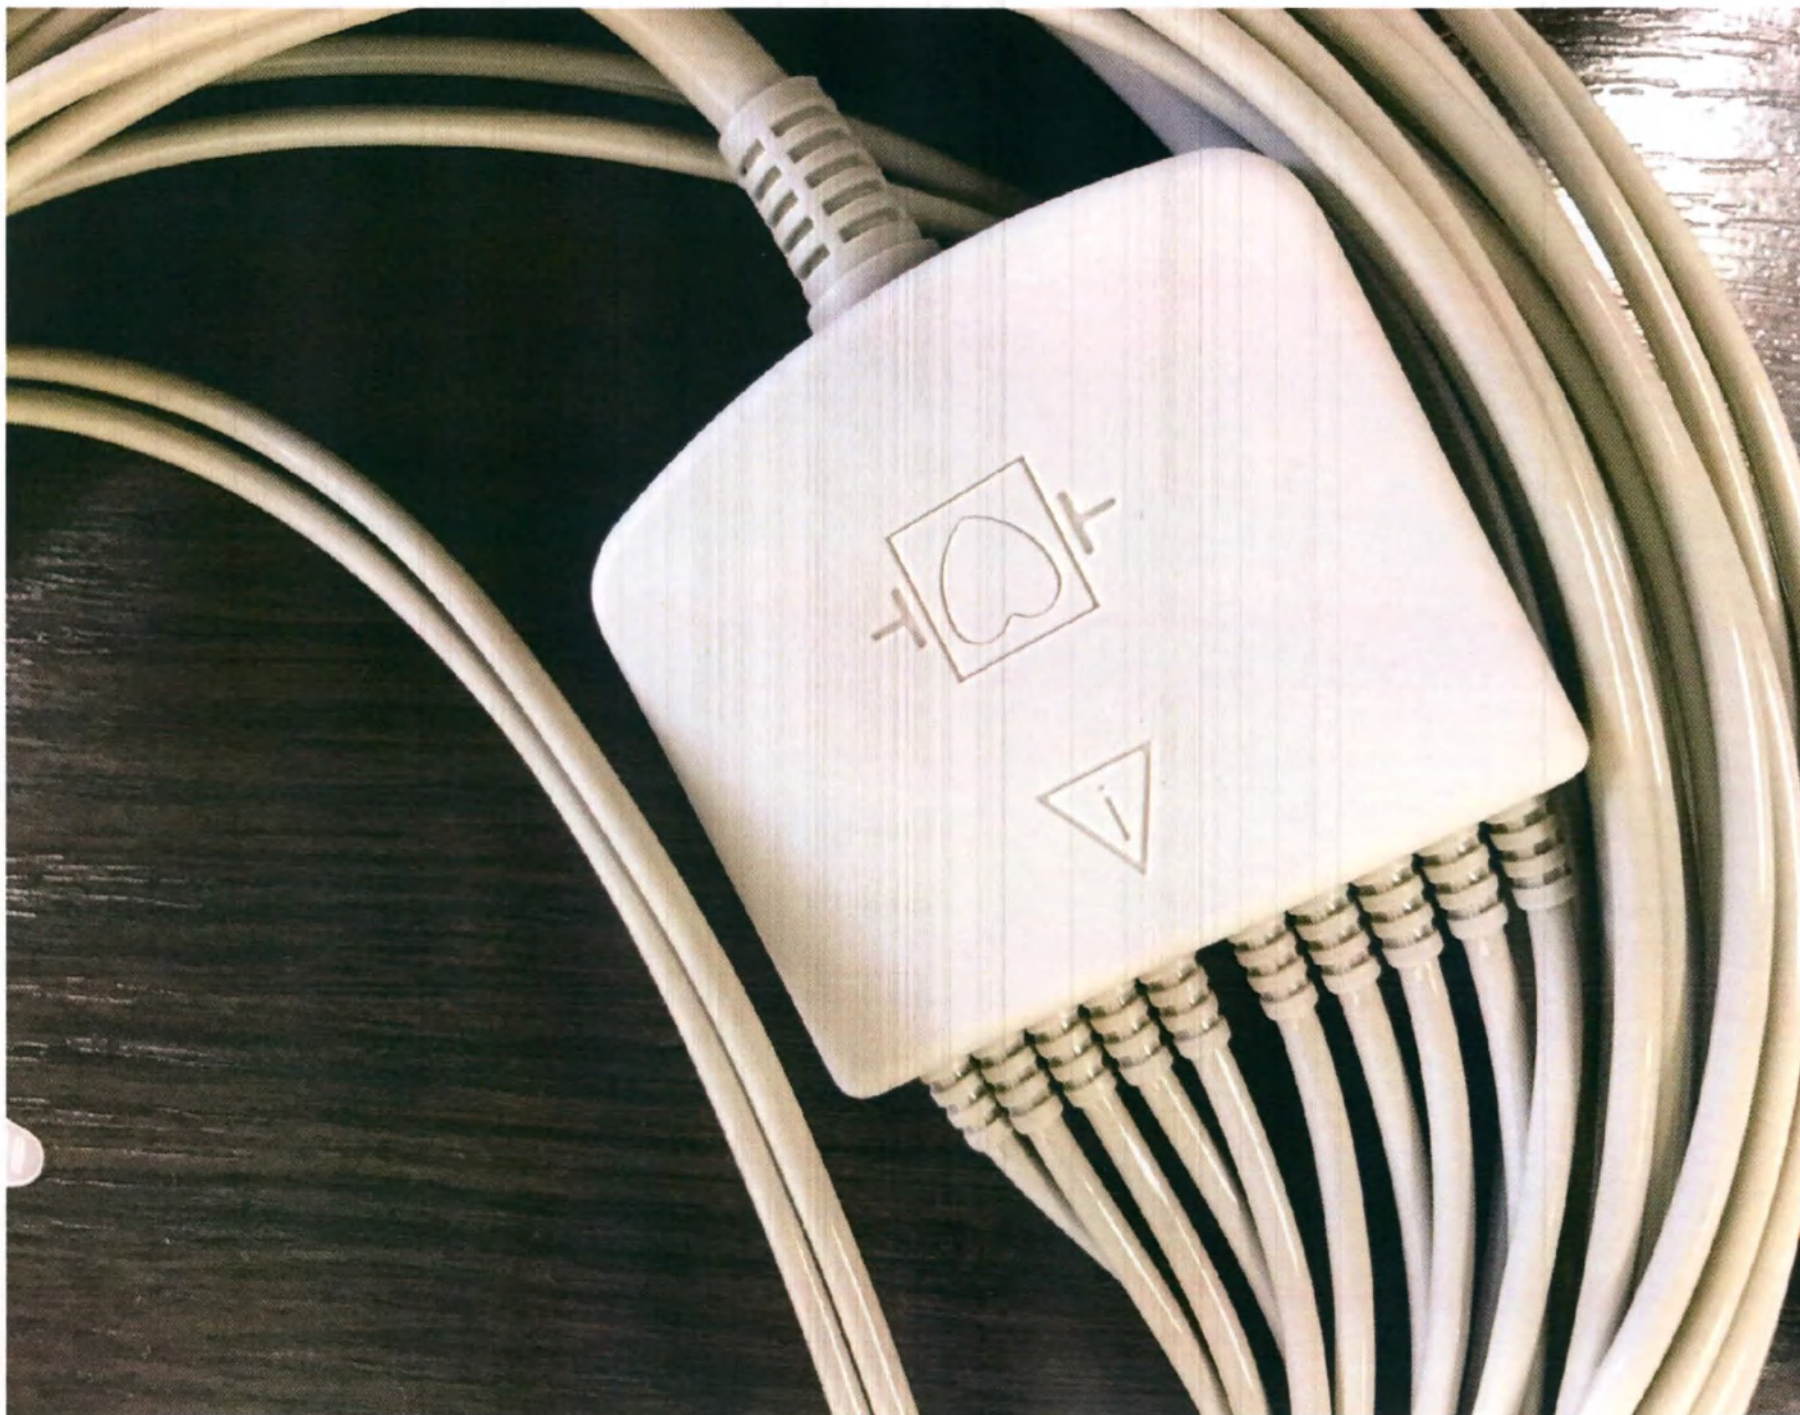

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (маркировка разъема отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (наклейка с серийным номером)

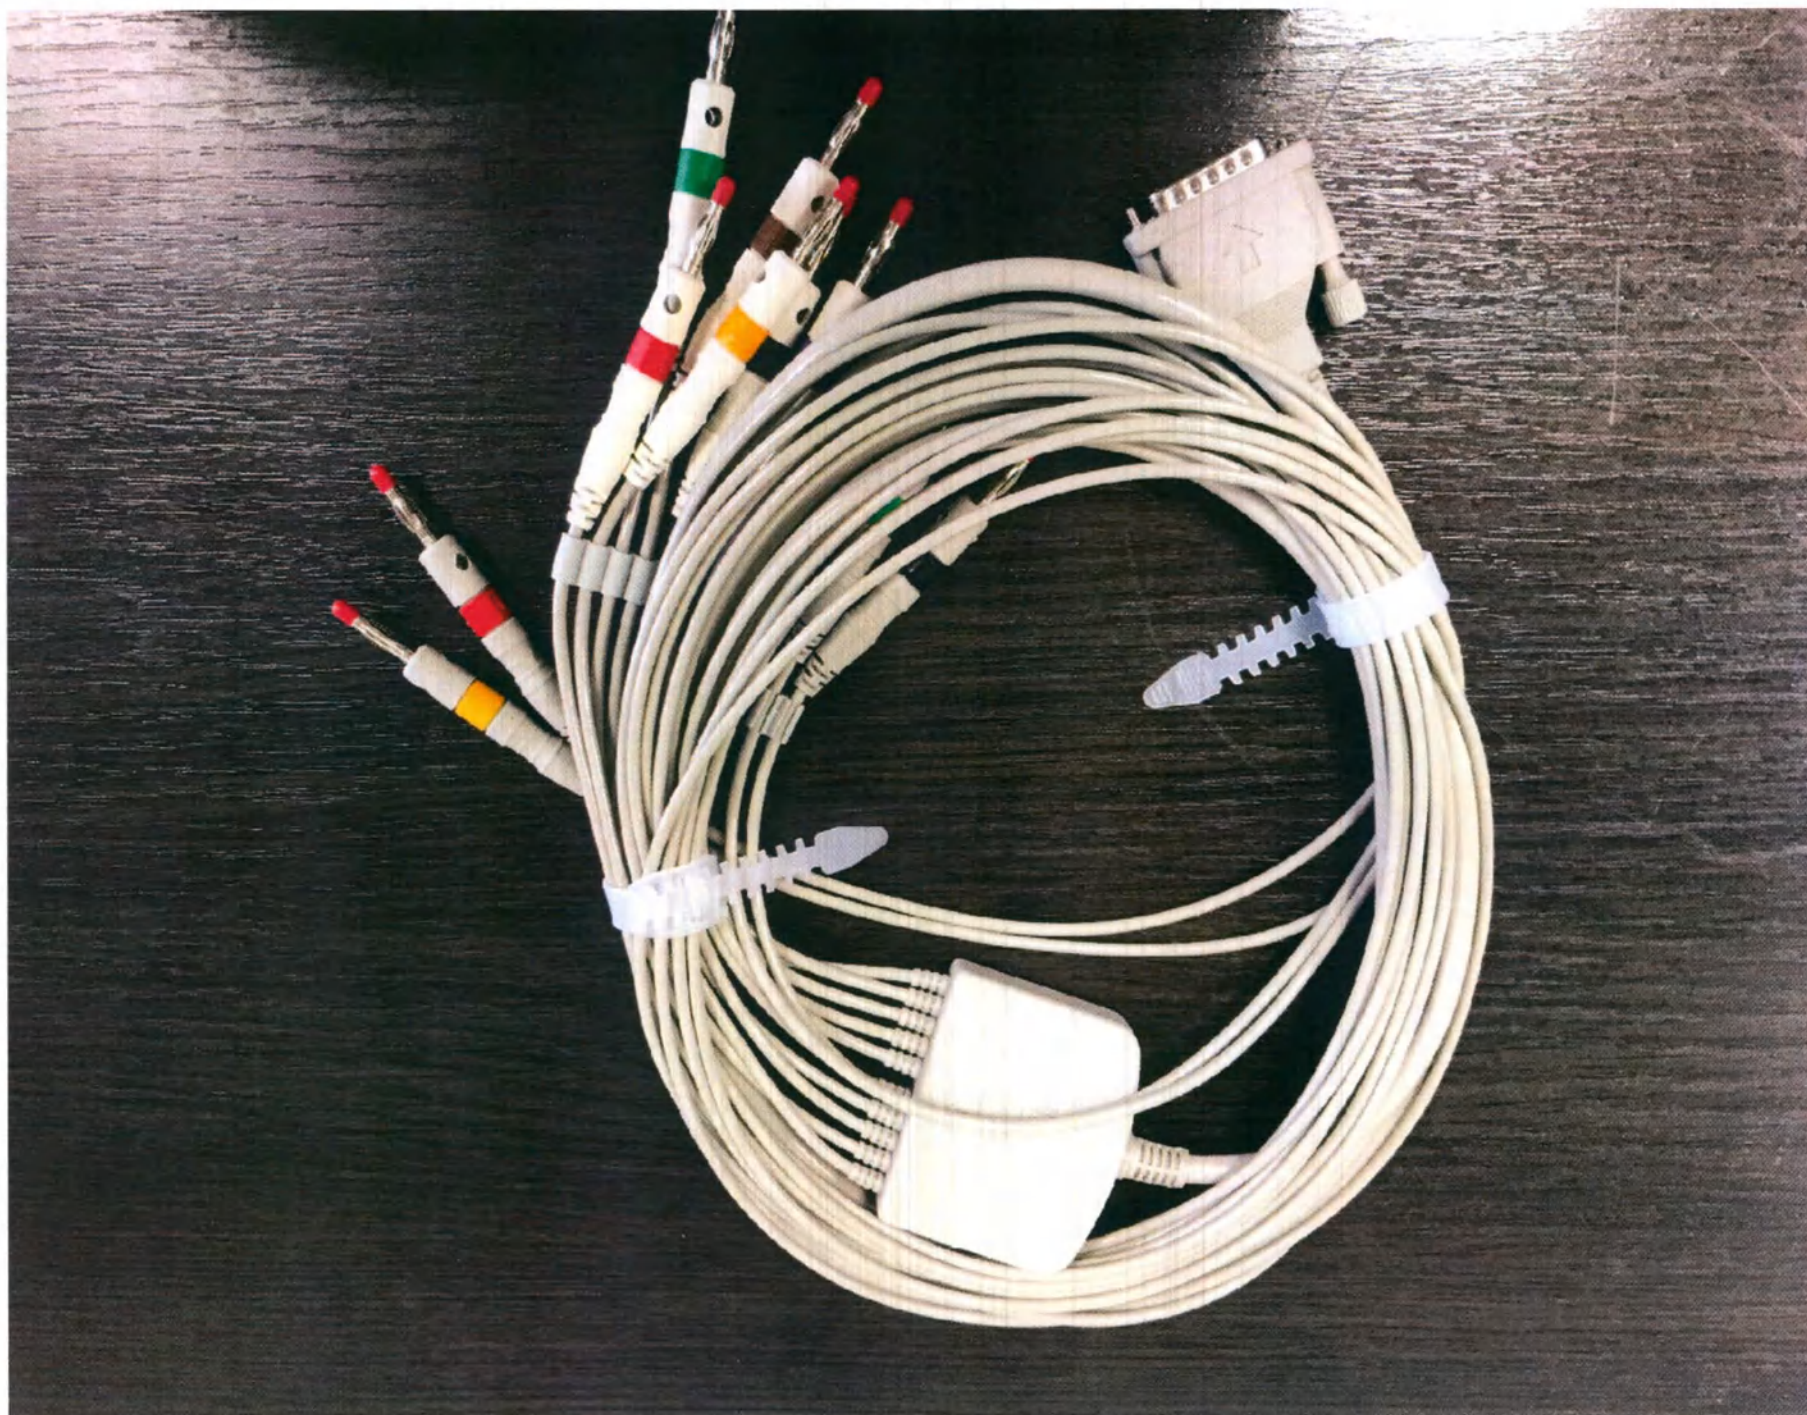

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (общий вид)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (разъем отведений)

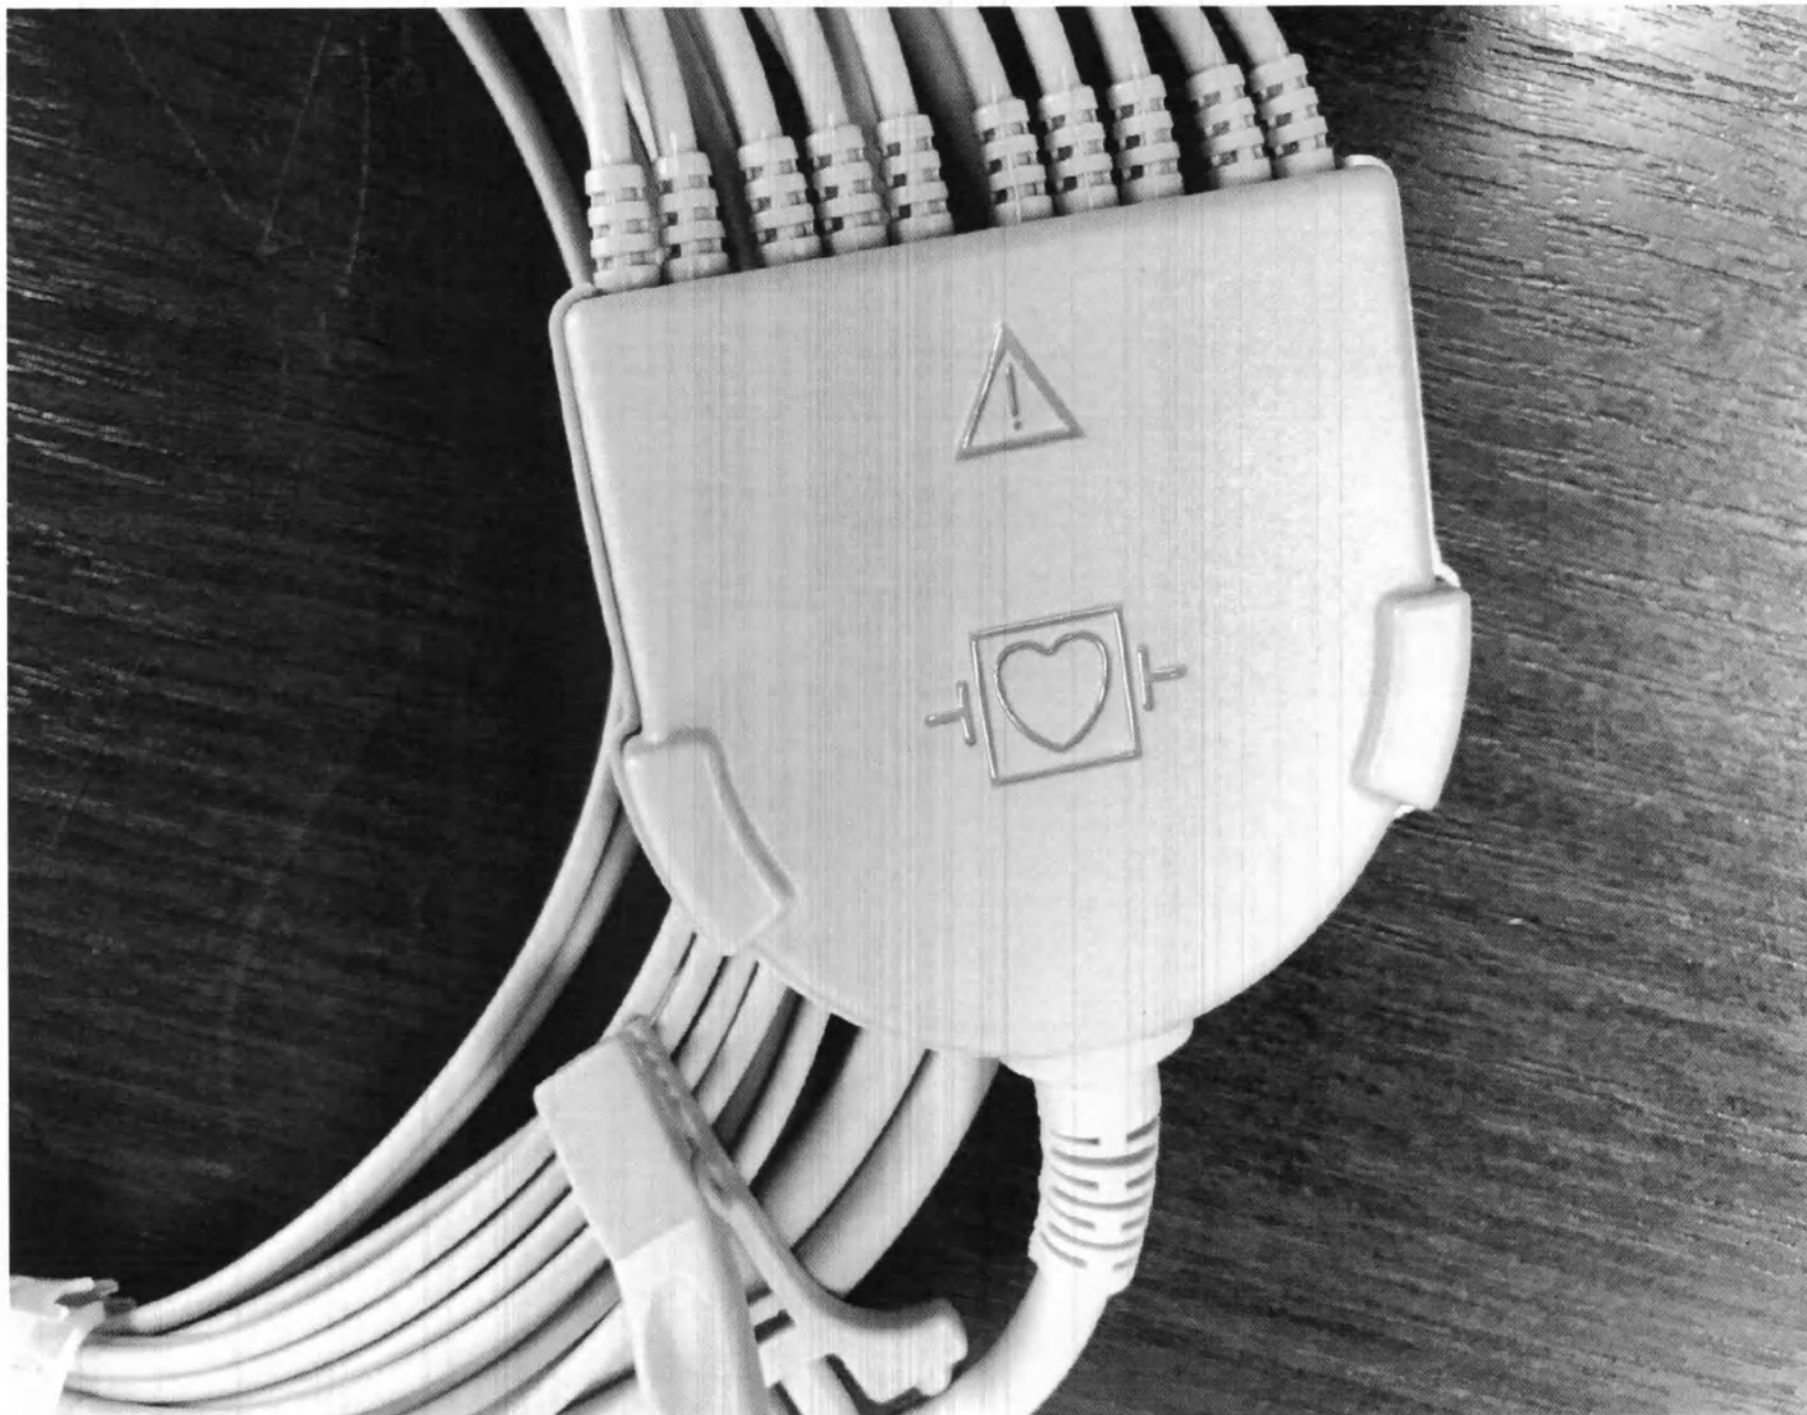

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (маркировка разъема отведений)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (наклейка с серийным номером)



Электрод-клипса для детей (в упаковке)



Электрод-клипса для детей (общий вид)




Электрод-клипса для детей (общий вид сбоку)



LOT ZH22040452211250029

 25.11.2022

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 1
Количество в упаковке – 4 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид)

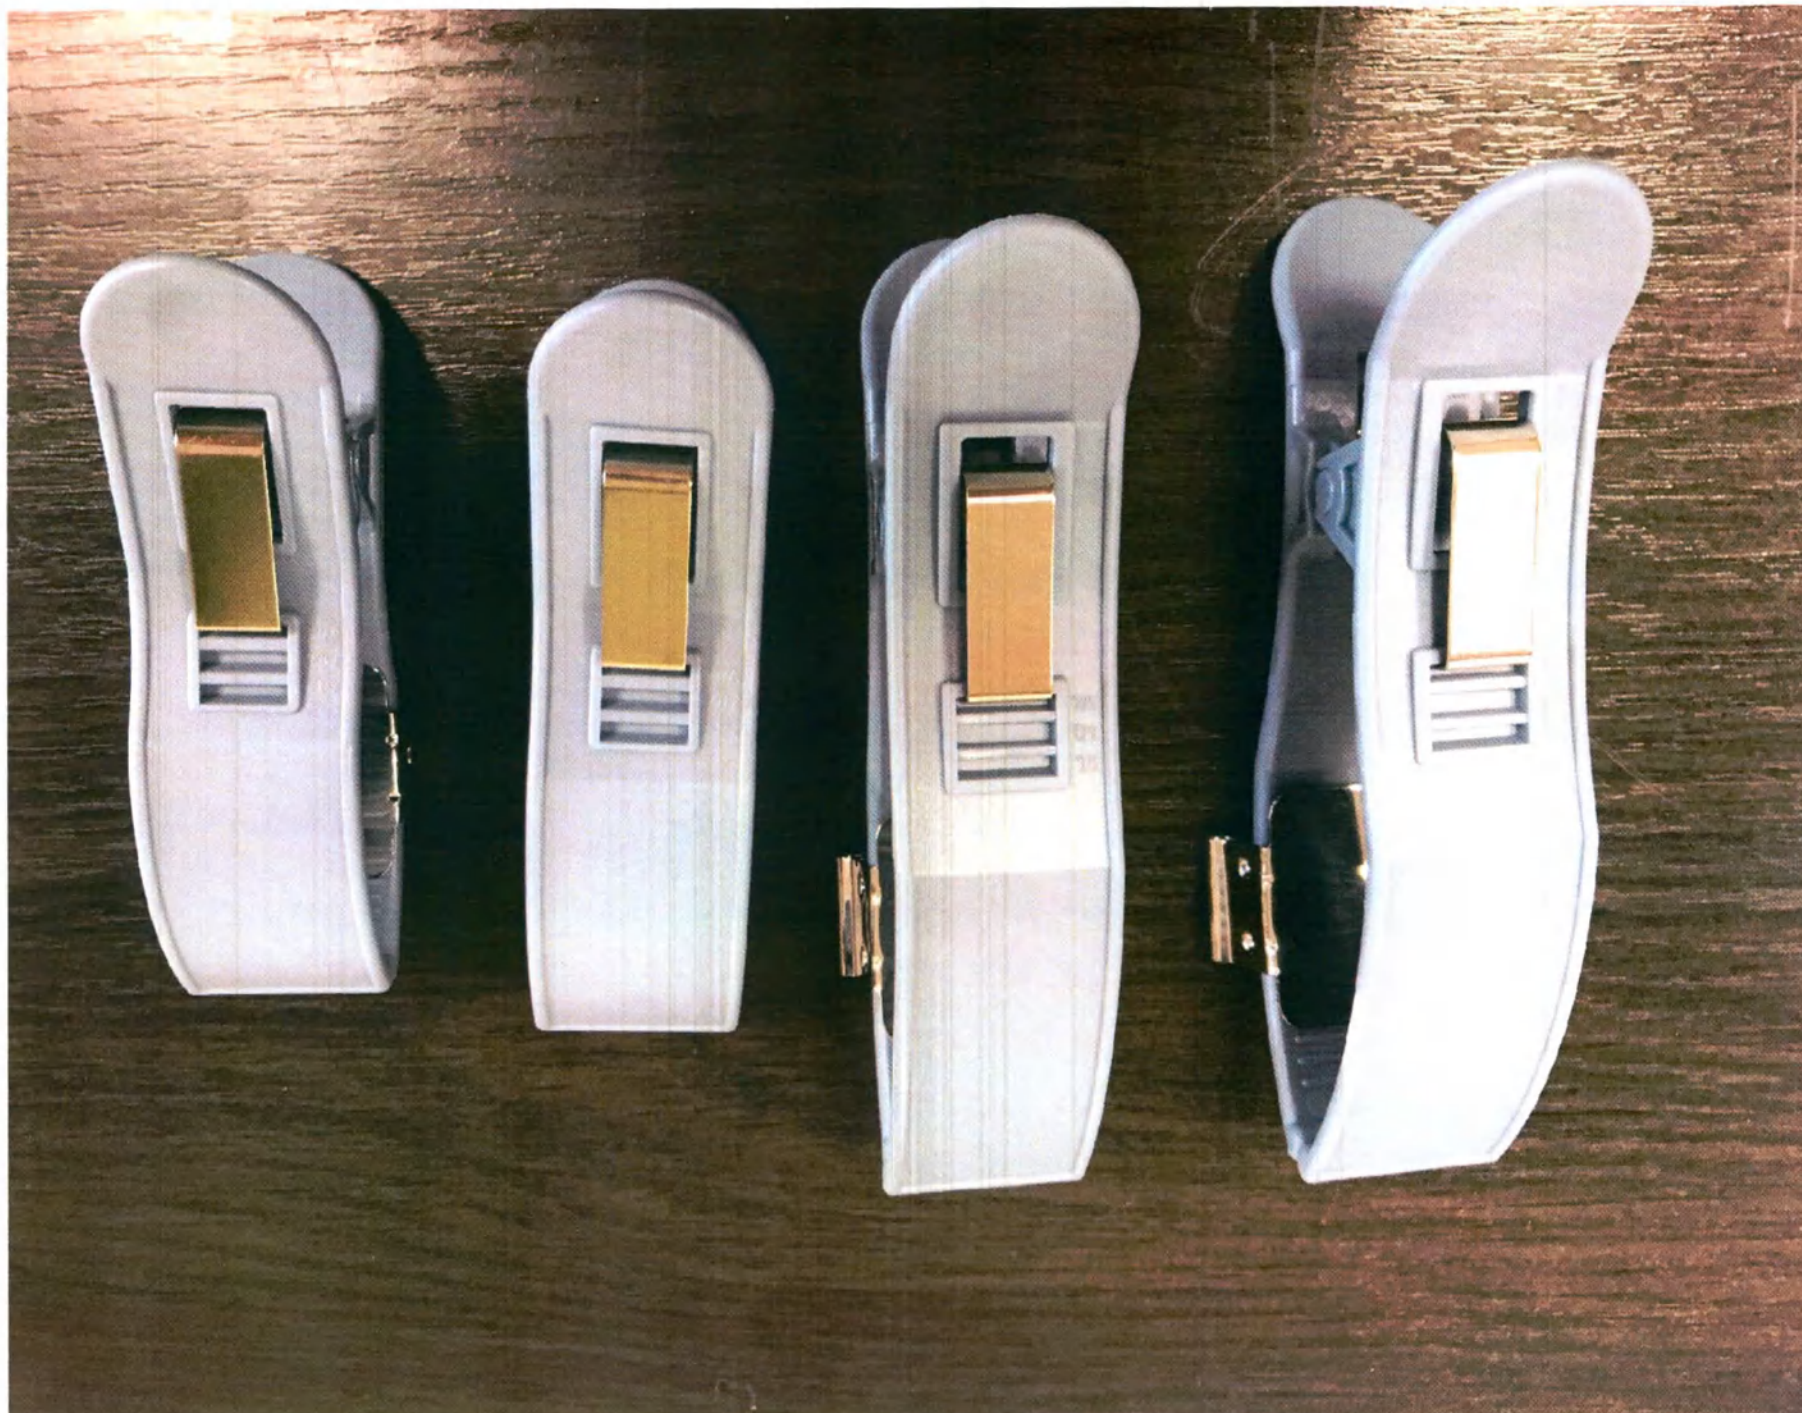

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид сбоку)



LOT 20230222-866

 22.02.2023

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 2
Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 2 (общий вид)




Электрод-груша для детей (в упаковке)



Электрод-груша для детей (упаковка)



Электрод-груша для детей (общий вид)

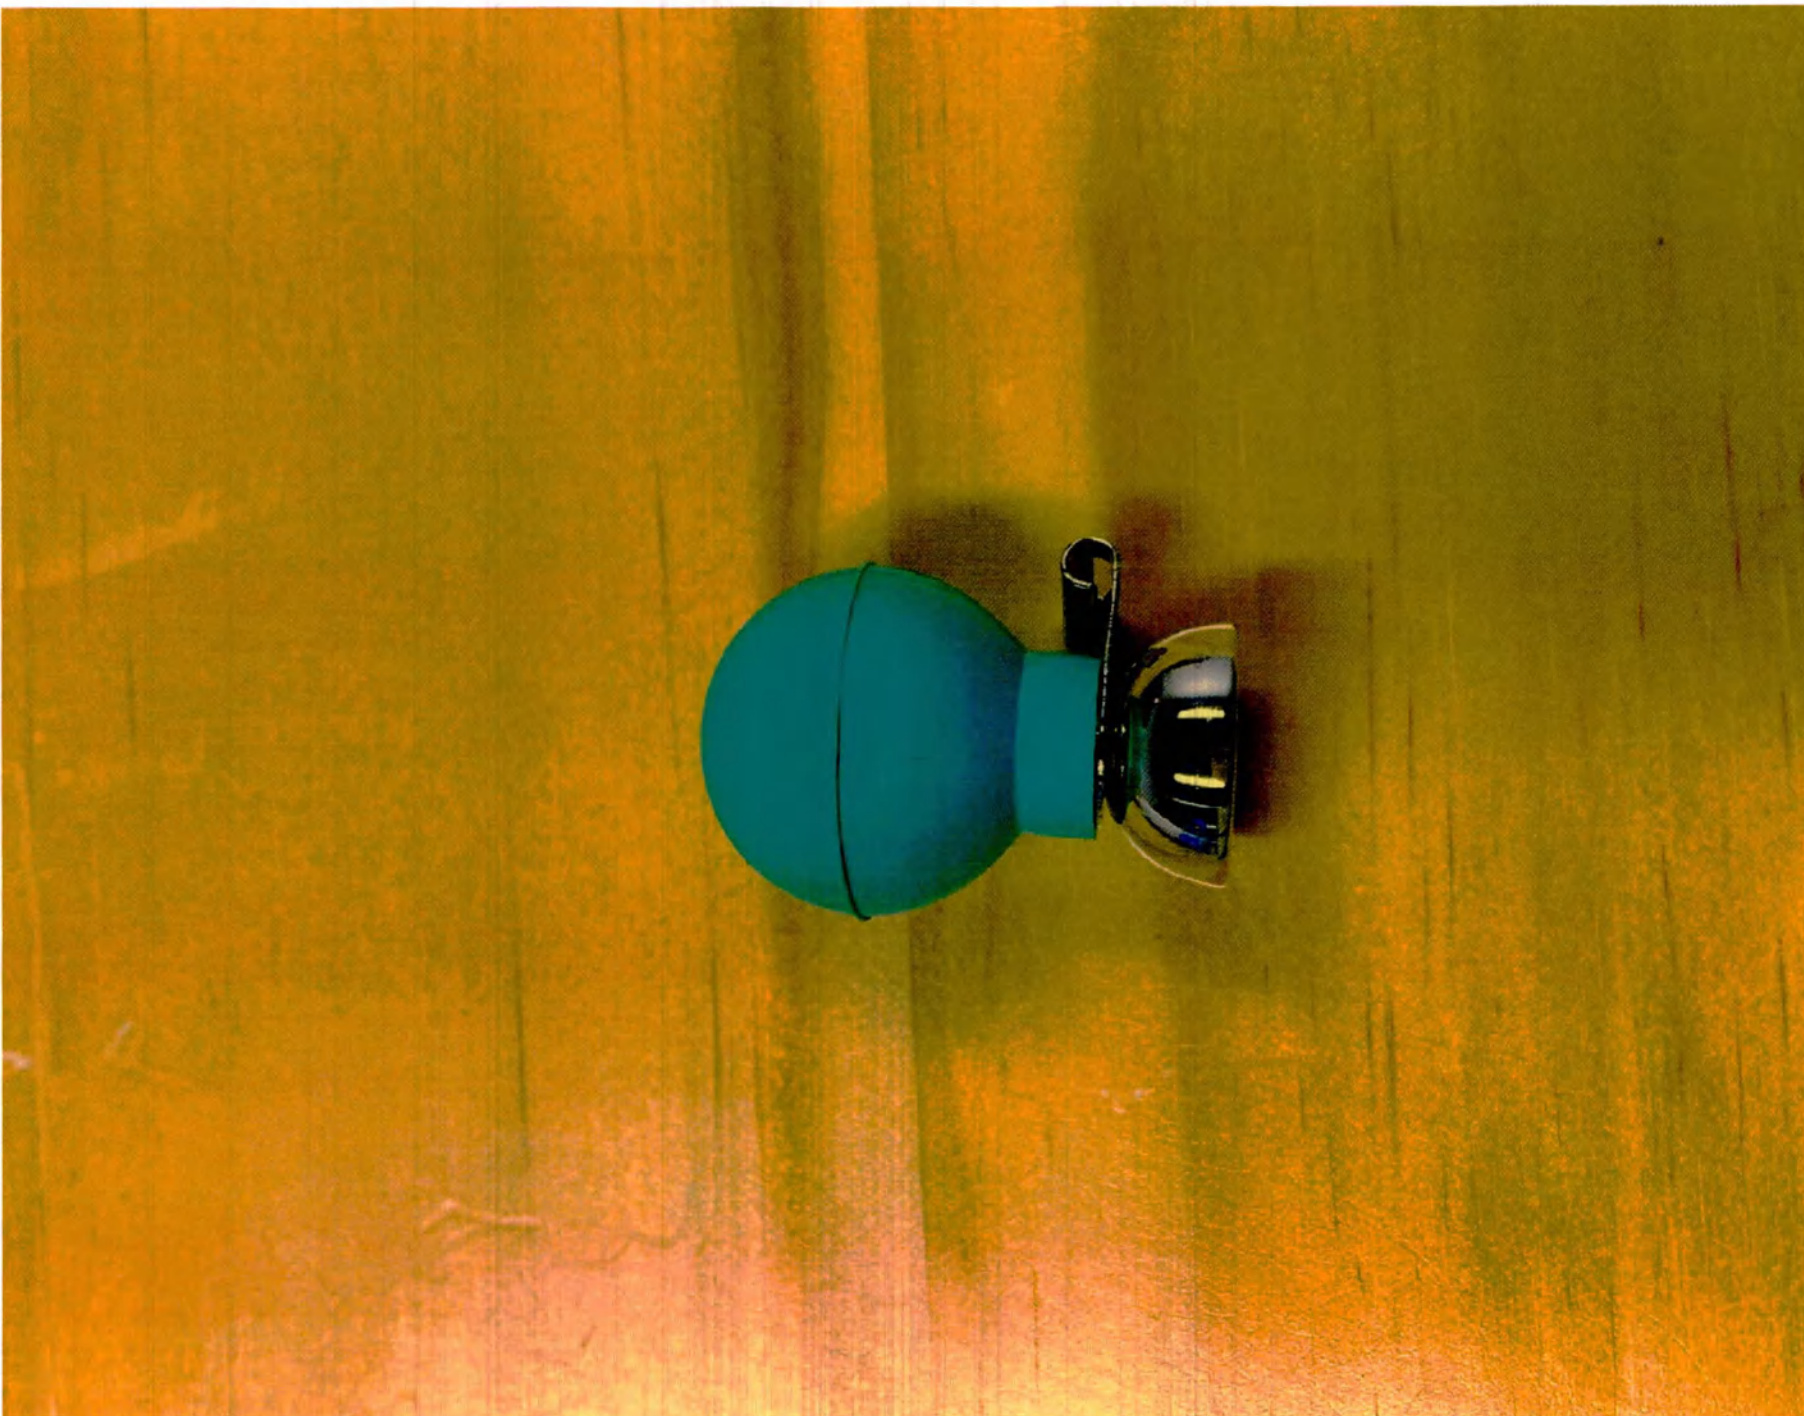


Электрод-груша для детей (общий вид)




Электрод-груша для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 1 (общий вид)

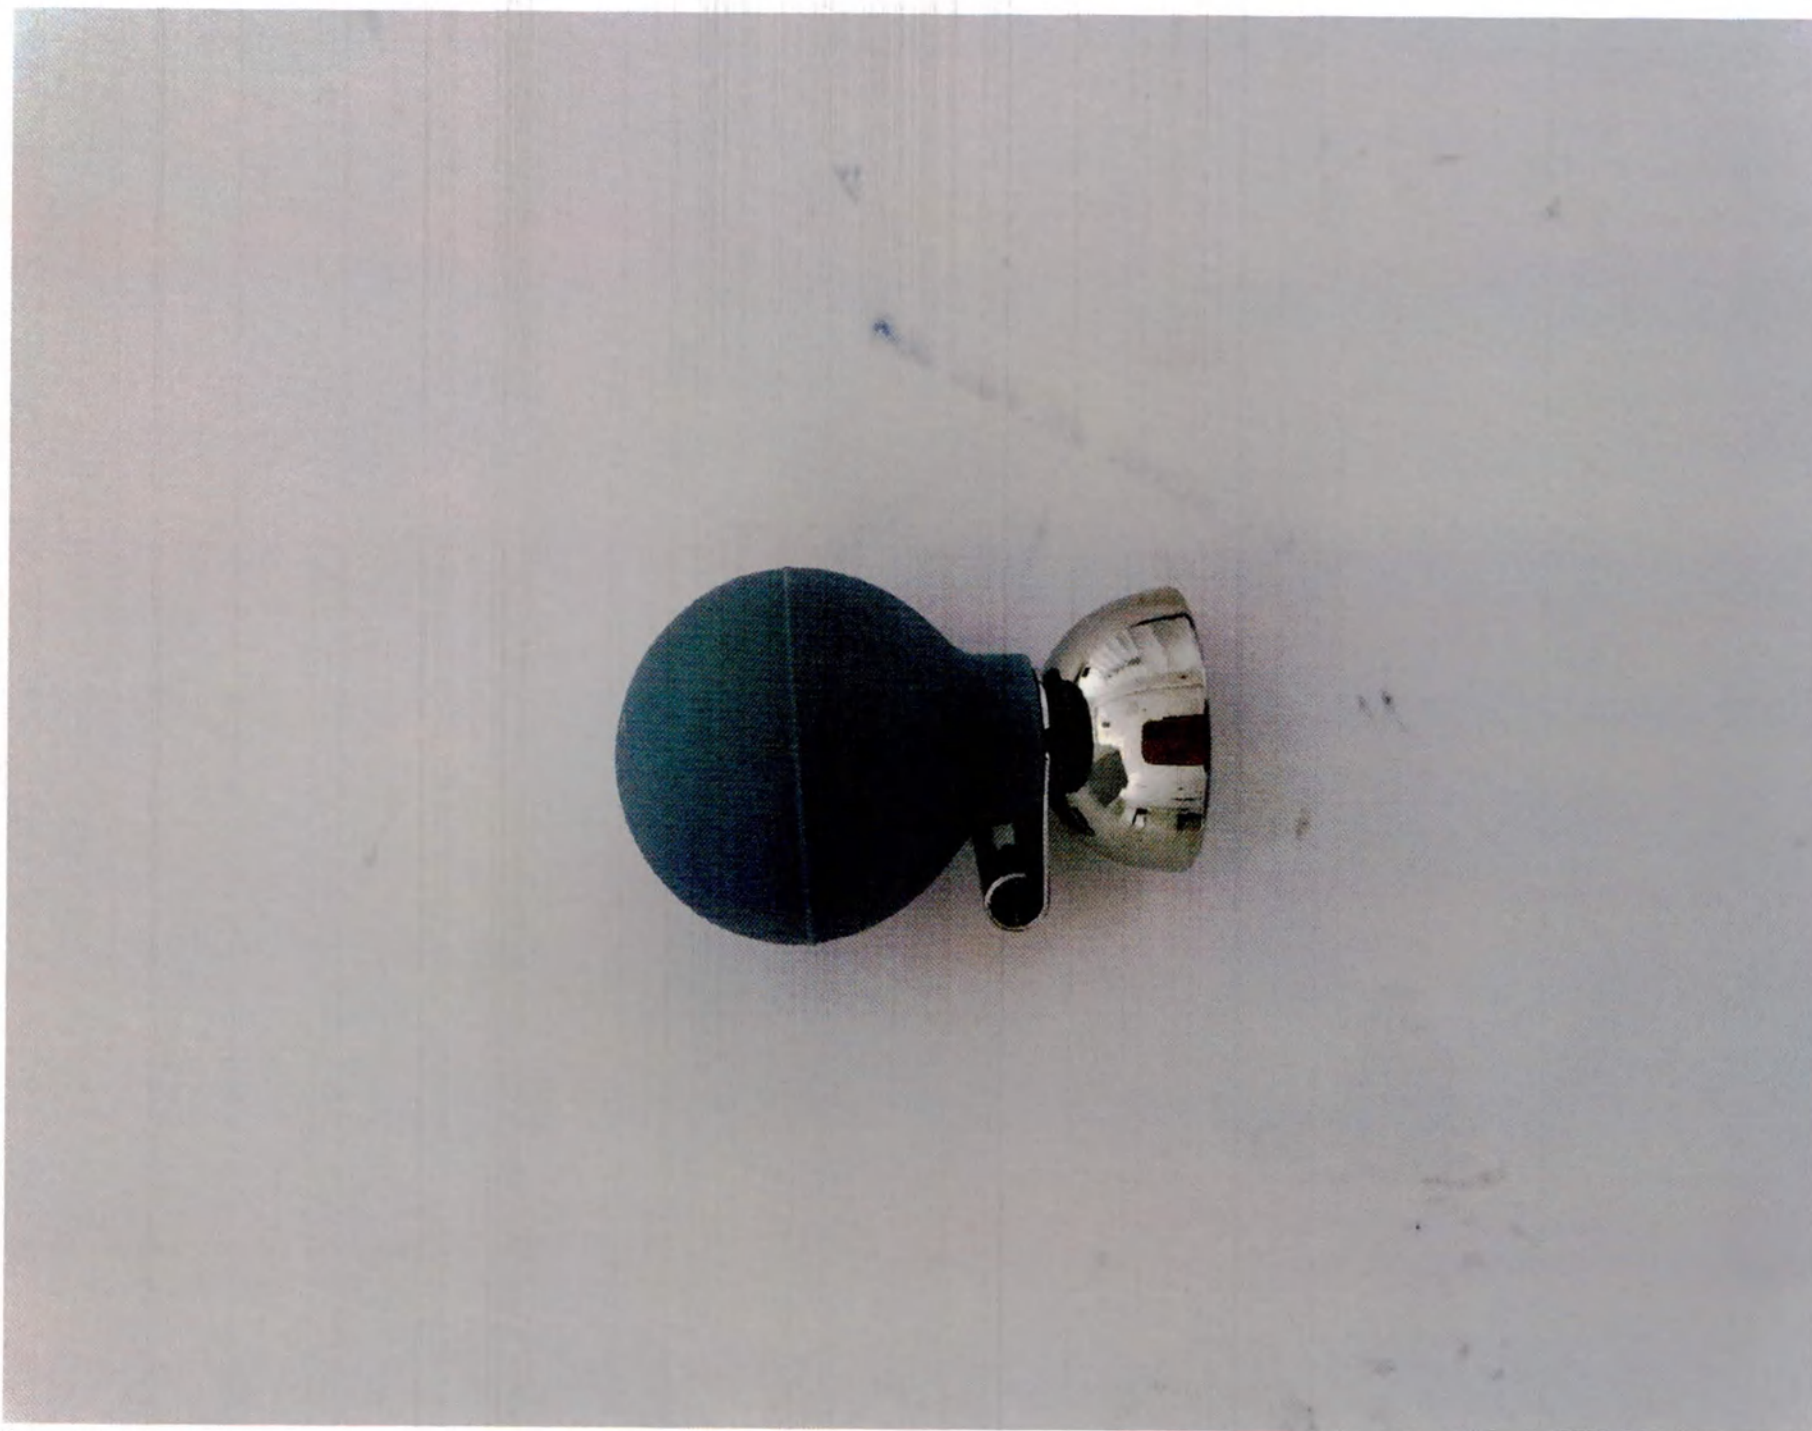

Электрод-груша для взрослых тип 1

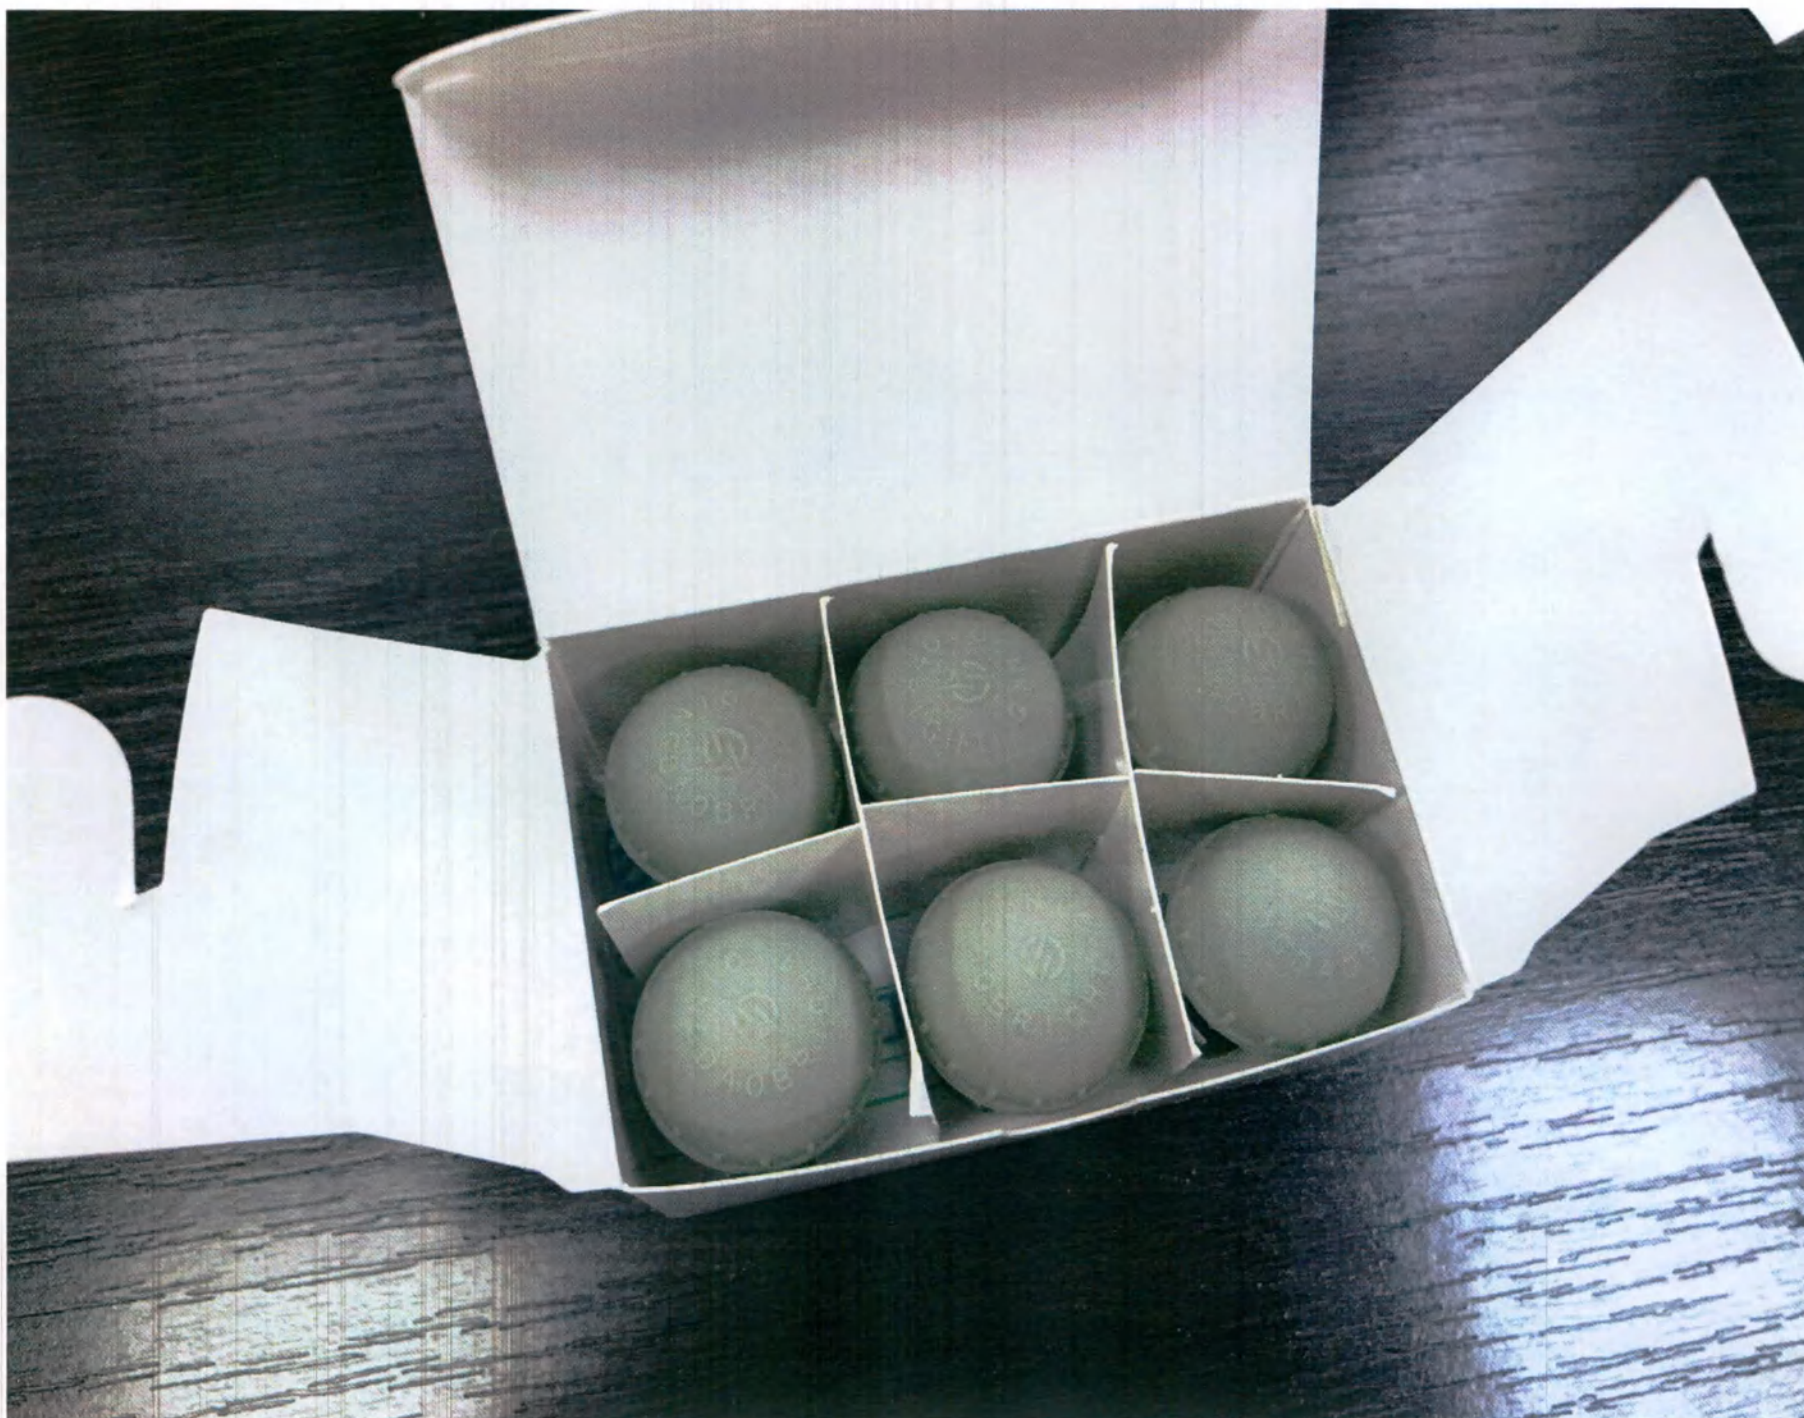

Электрод-груша для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 2 (общий вид)



Электрод-груша для взрослых тип 2

LOT

22110400017



30.10.2022

COMEN**Электрод-клипса для детей**

Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China


Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,

ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.


Регистрационное удостоверение №

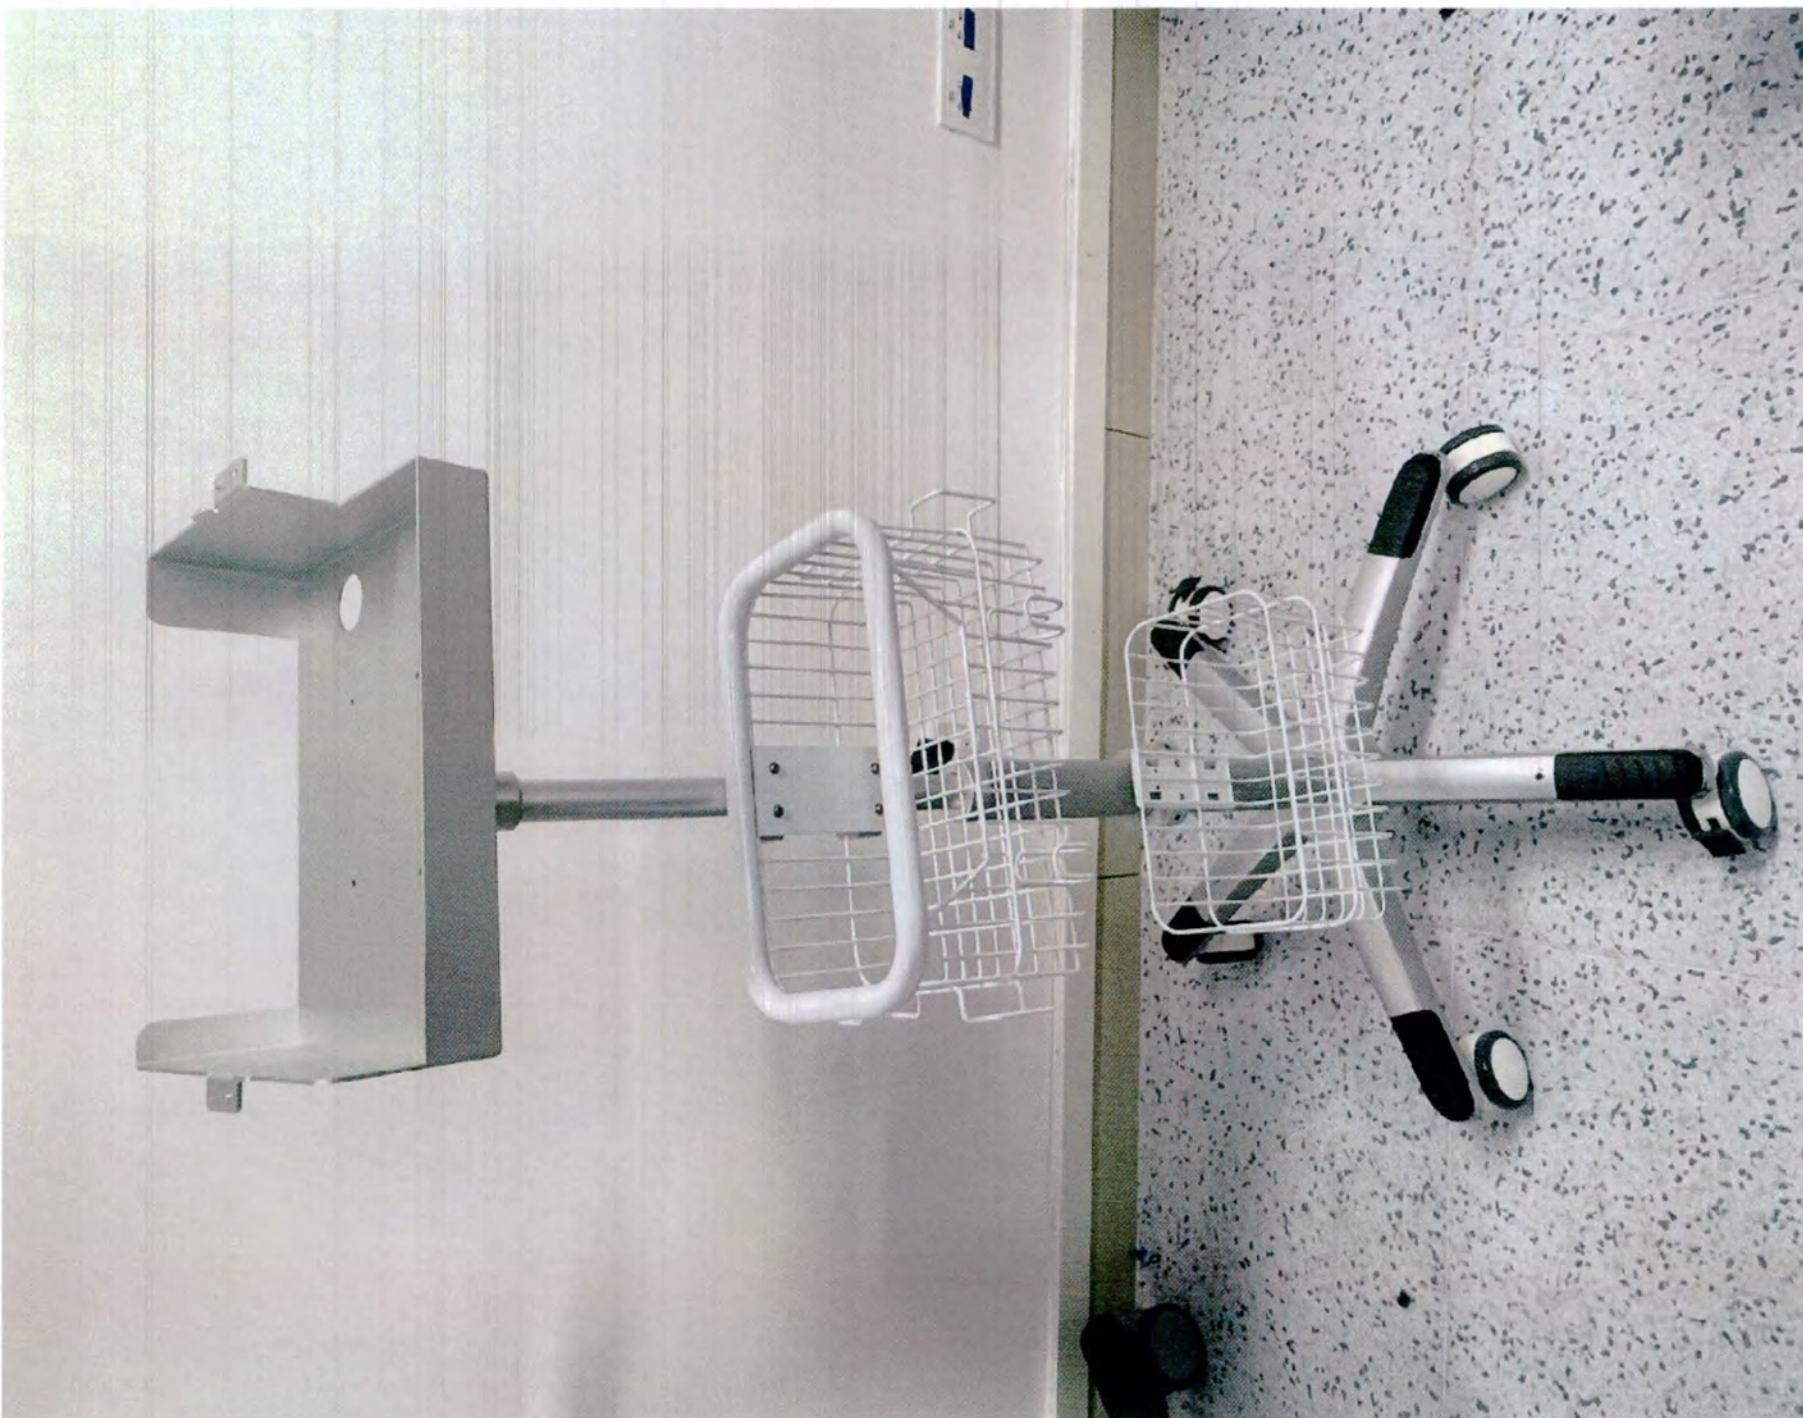

Тележка для ЭКГ модели НЗ



Бумага для печати для модели НЗ

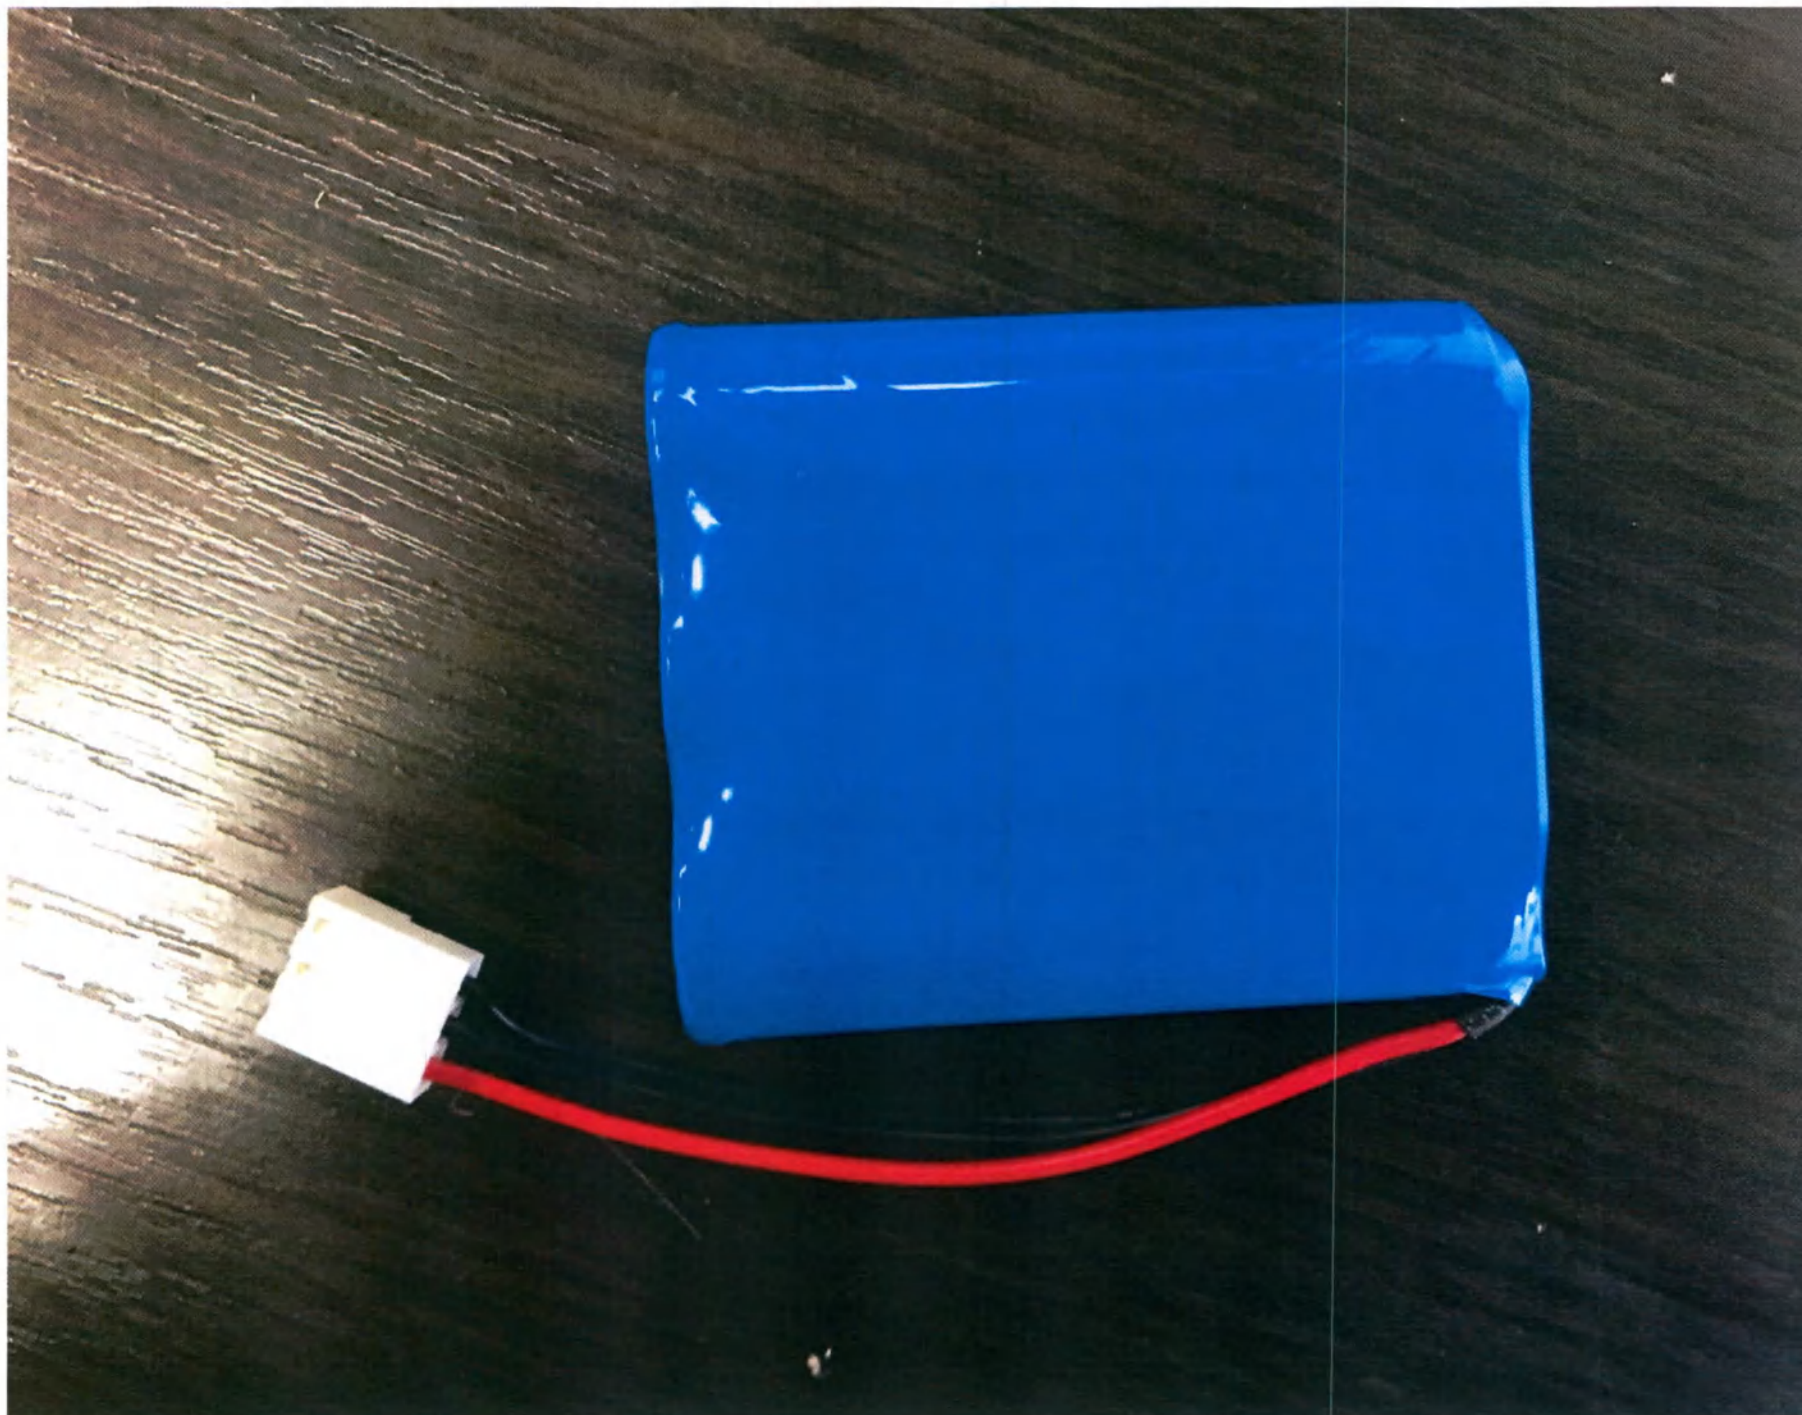

Батарея литиевая для моделей CM1200B, H3

可充电锂离子电池
Rechargeable Li-Ion Battery

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司
SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.


Model: CMLI1X3N001A

3ICR19/65

11.1V == 2200mAh/24Wh

MADE IN CHINA

中国制造



SN

(序列编号)



(YYYY-MM-DD)

SHR082012202207140014
2022-07-14-20

警告：

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C(-4°F)至60°C(140°F)温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。推荐使用的最高环境温度为45°C(125°F)。

CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Don't crush, puncture, disassemble or short circuit the battery in -20°C(-4°F) to 60°C(140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use. Maximum Recommended Ambient is 45°C(125°F).

Батарея литиевая для моделей CM1200B, H3 (маркировка)

Электрокардиограф Н12



Электрокардиограф Н12: транспортная/потребительская коробка



Электрокардиограф Н12: манипуляционные надписи и знаки на транспортной/потребительской коробке

MODEL: **H12**

DATE: **2022.11.17**

NUMBER: **H2221104030**

ORDER NO#: **FG20221111**



H2221104030

Электрокардиограф H12: идентификационная наклейка на транспортной/потребительской коробке

COMEN

Электрокардиограф Н12

Регистрационное удостоверение № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Размер упаковки: 405мм (длина)х 194мм (глубина) 350мм (высота)

Масса нетто: 3,7 кг Масса брутто: 4,0 кг Количество в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)


Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ.


6Н С НОМ 39.49



THIS WAY UP




FRAGILE




STACKING
LIMITS




KEEP AWAY
FROM RAIN



TEMPERATURE
LIMIT



HUMIDITY
LIMITATION



ATMOSPHERIC
PRESSURE LIMITATION

Электрокардиограф Н12: маркировка транспортной/потребительской коробки



Блок базовый Н12 (в воздушных пакетах для предотвращения повреждений)




Блок базовый Н12 (вид сверху, передняя панель)




Блок базовый H12 (вид спереди)



Блок базовый Н12 (вид сбоку)

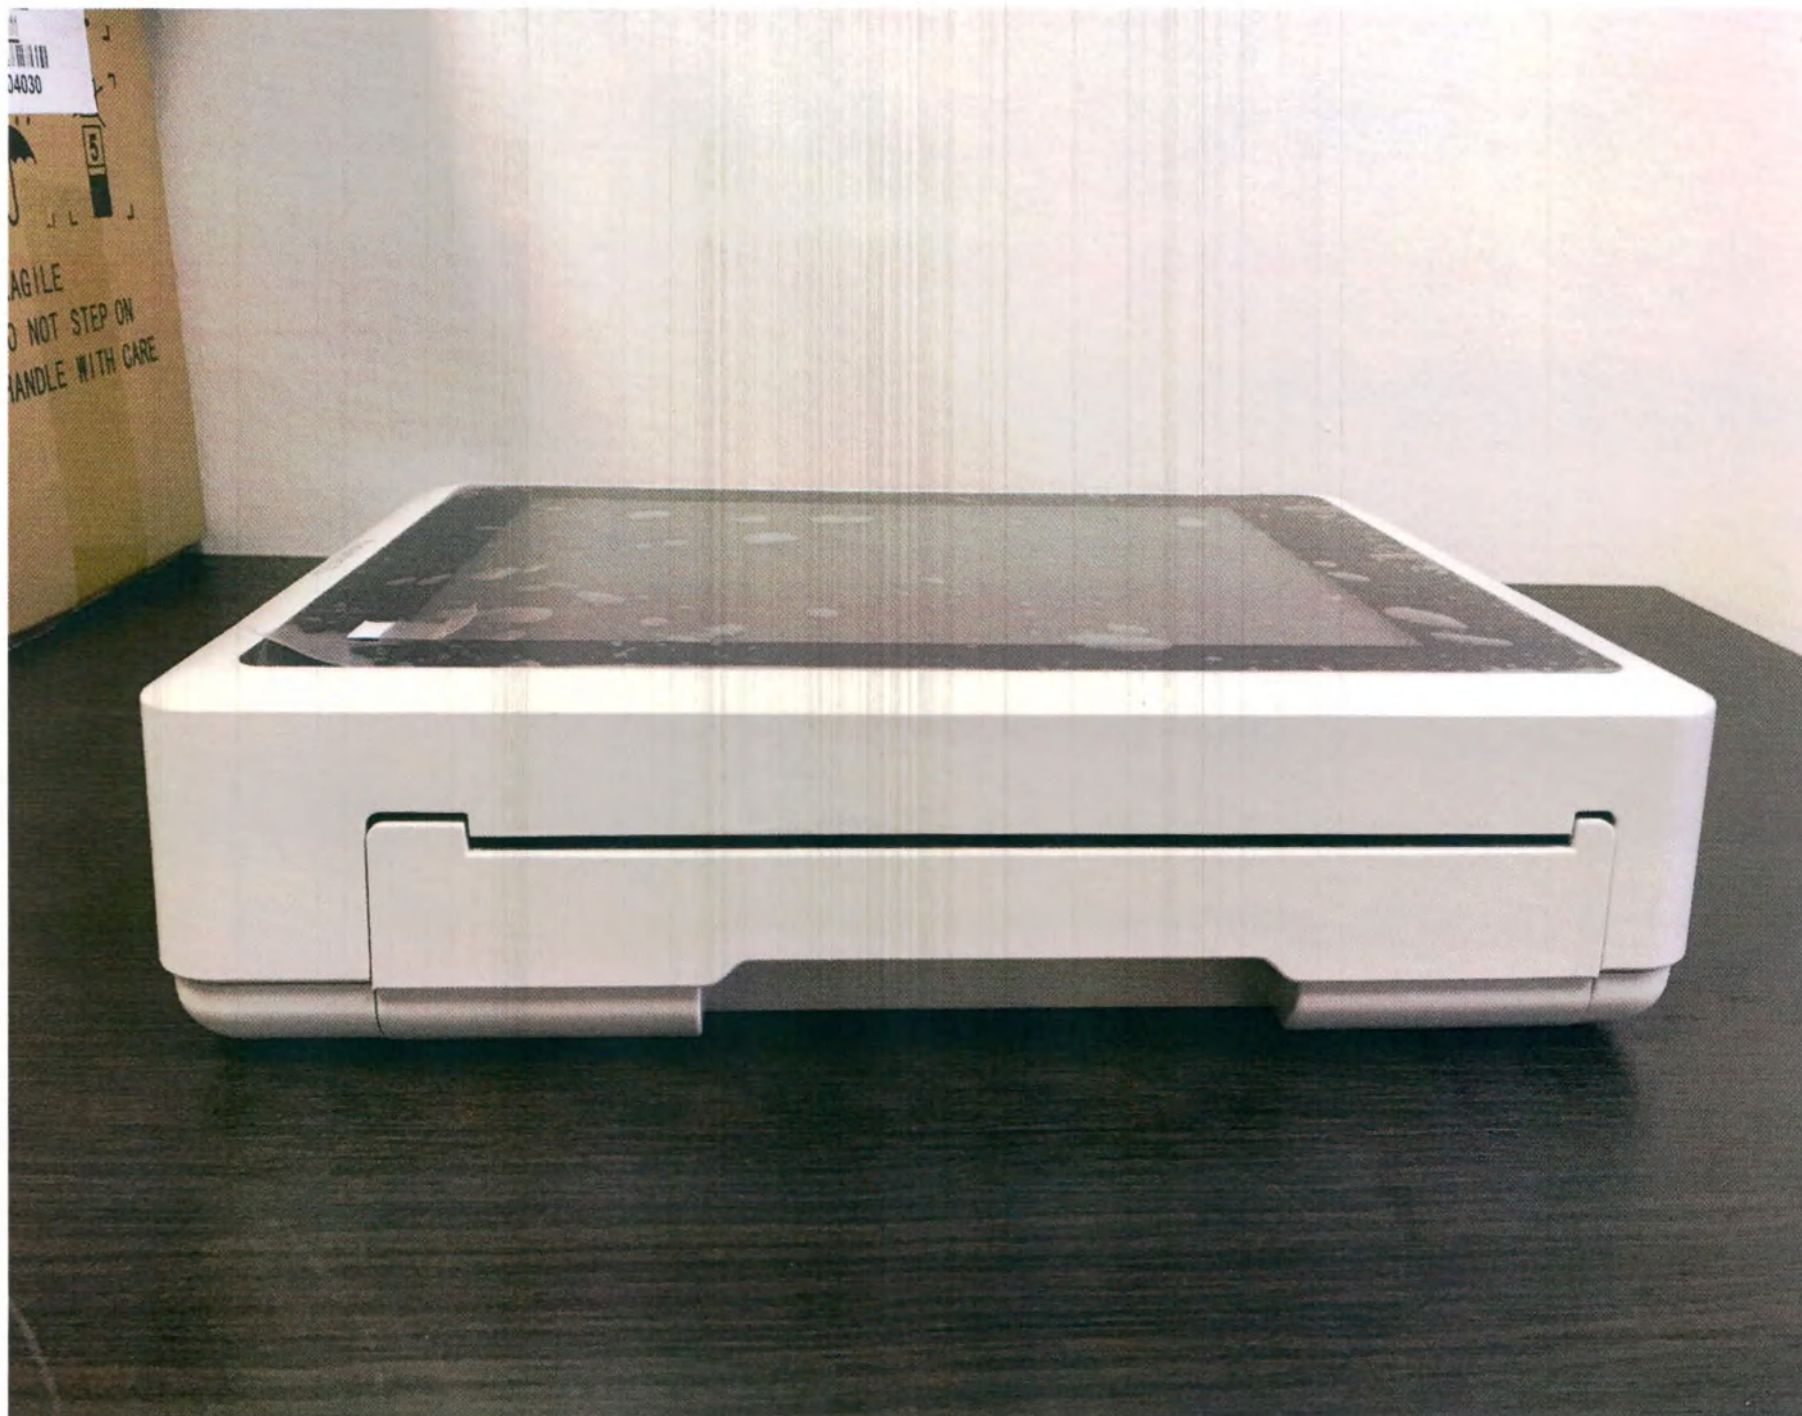

Блок базовый Н12 (вид сбоку)

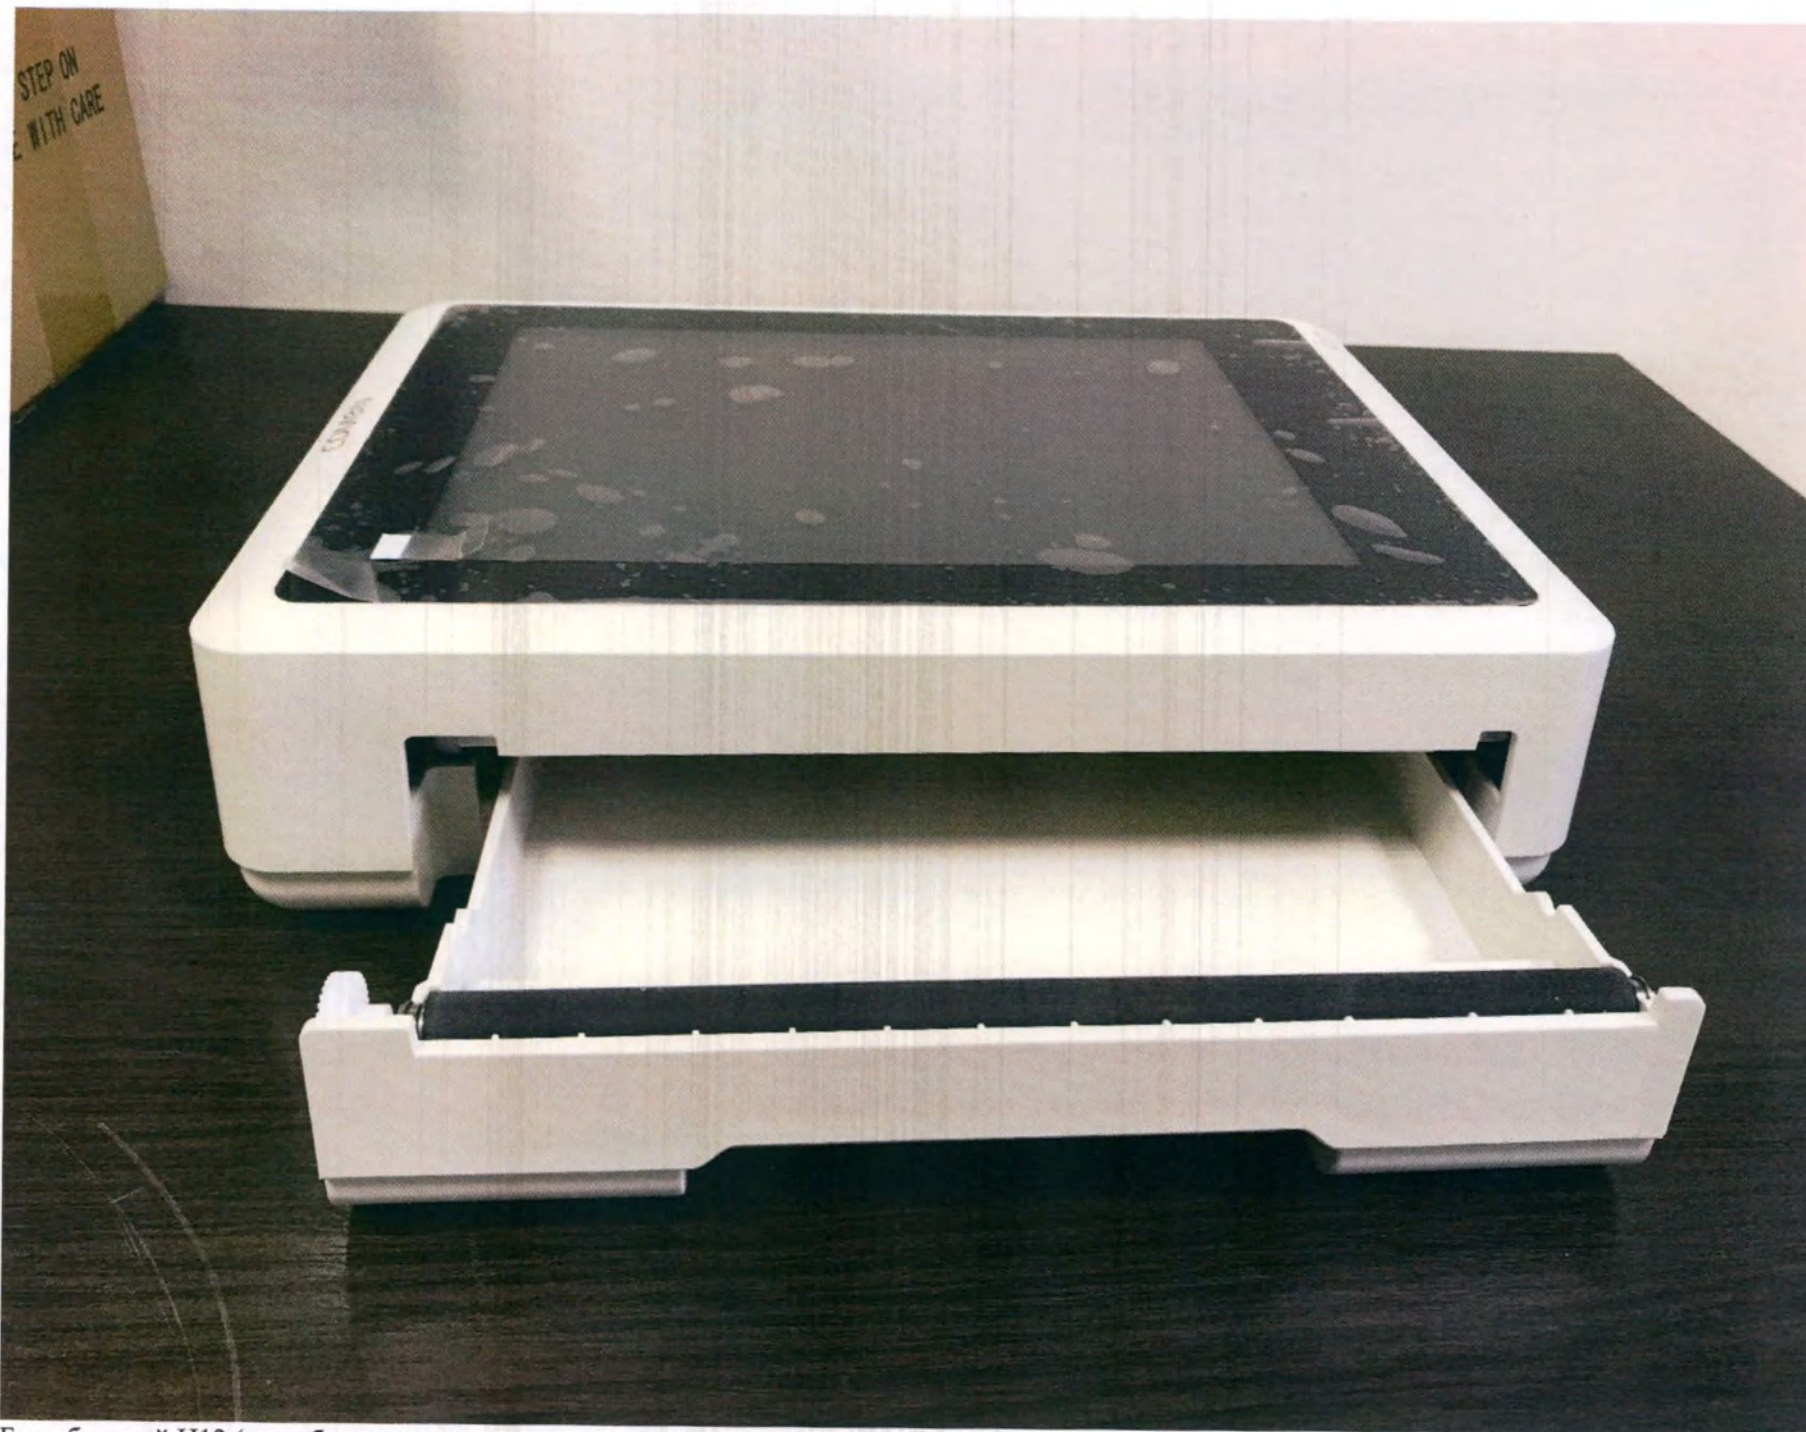

Блок базовый Н12 (вид сбоку, с открытым принтером)




Блок базовый H12 (сверху)

SN H2221104030

 04.11.2022

COMEN



Электрокардиограф Н12

Номинальное напряжение: 100-240В~

Номинальная частота: 50/60Гц

Номинальная мощность: 100ВА

Регистрационное удостоверение

№ РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.



IPX0



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)


Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ № 21, Киришская ул., д. 2, литера А, офис часть помещ. 6Н С НОМ 39.49

Блок базовый Н12 (маркировка)

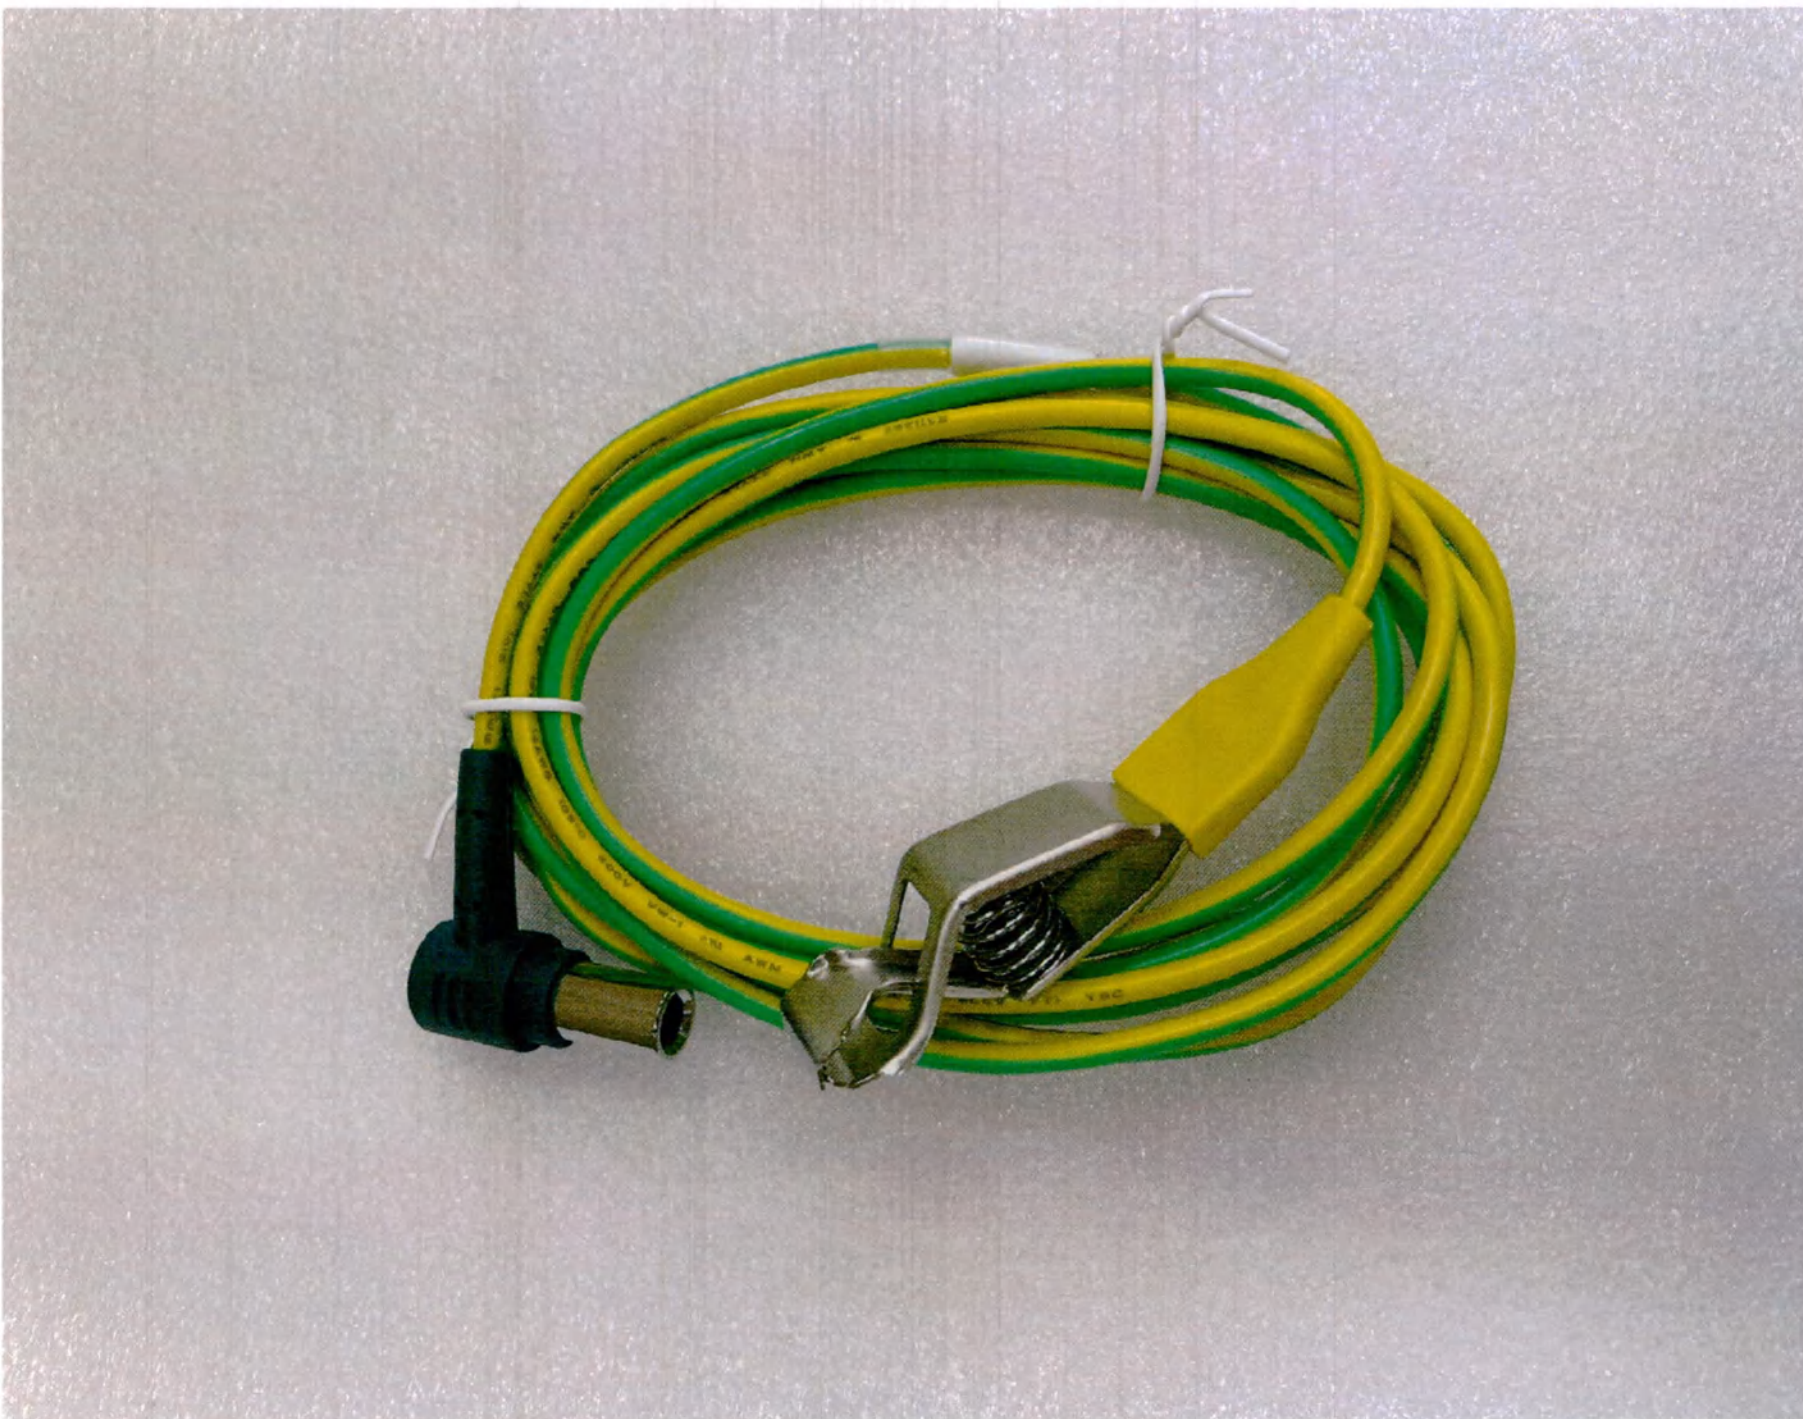


Кабель заземления



Кабель питания

Revision 1 / Редакция 1

	«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ» Director General / Генеральный директор Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./ Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.  Yi Yong (И Юн) « 02 » 02 2023 г. Stamp/печать
--	---

USER MANUAL OF MEDICAL DEVICE/
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Electrocardiograph, in versions/
 Электрокардиограф, в вариантах исполнения**

**Electrocardiograph H12/
 Электрокардиограф H12**

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./
 Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.





Кабель ЭКГ на 12 отведений: Пример индивидуальной упаковки

SN**20230303 0031****03.03.2023****COMEN****Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1**

Количество в упаковке – 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.


(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China


Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.


Регистрационное удостоверение №

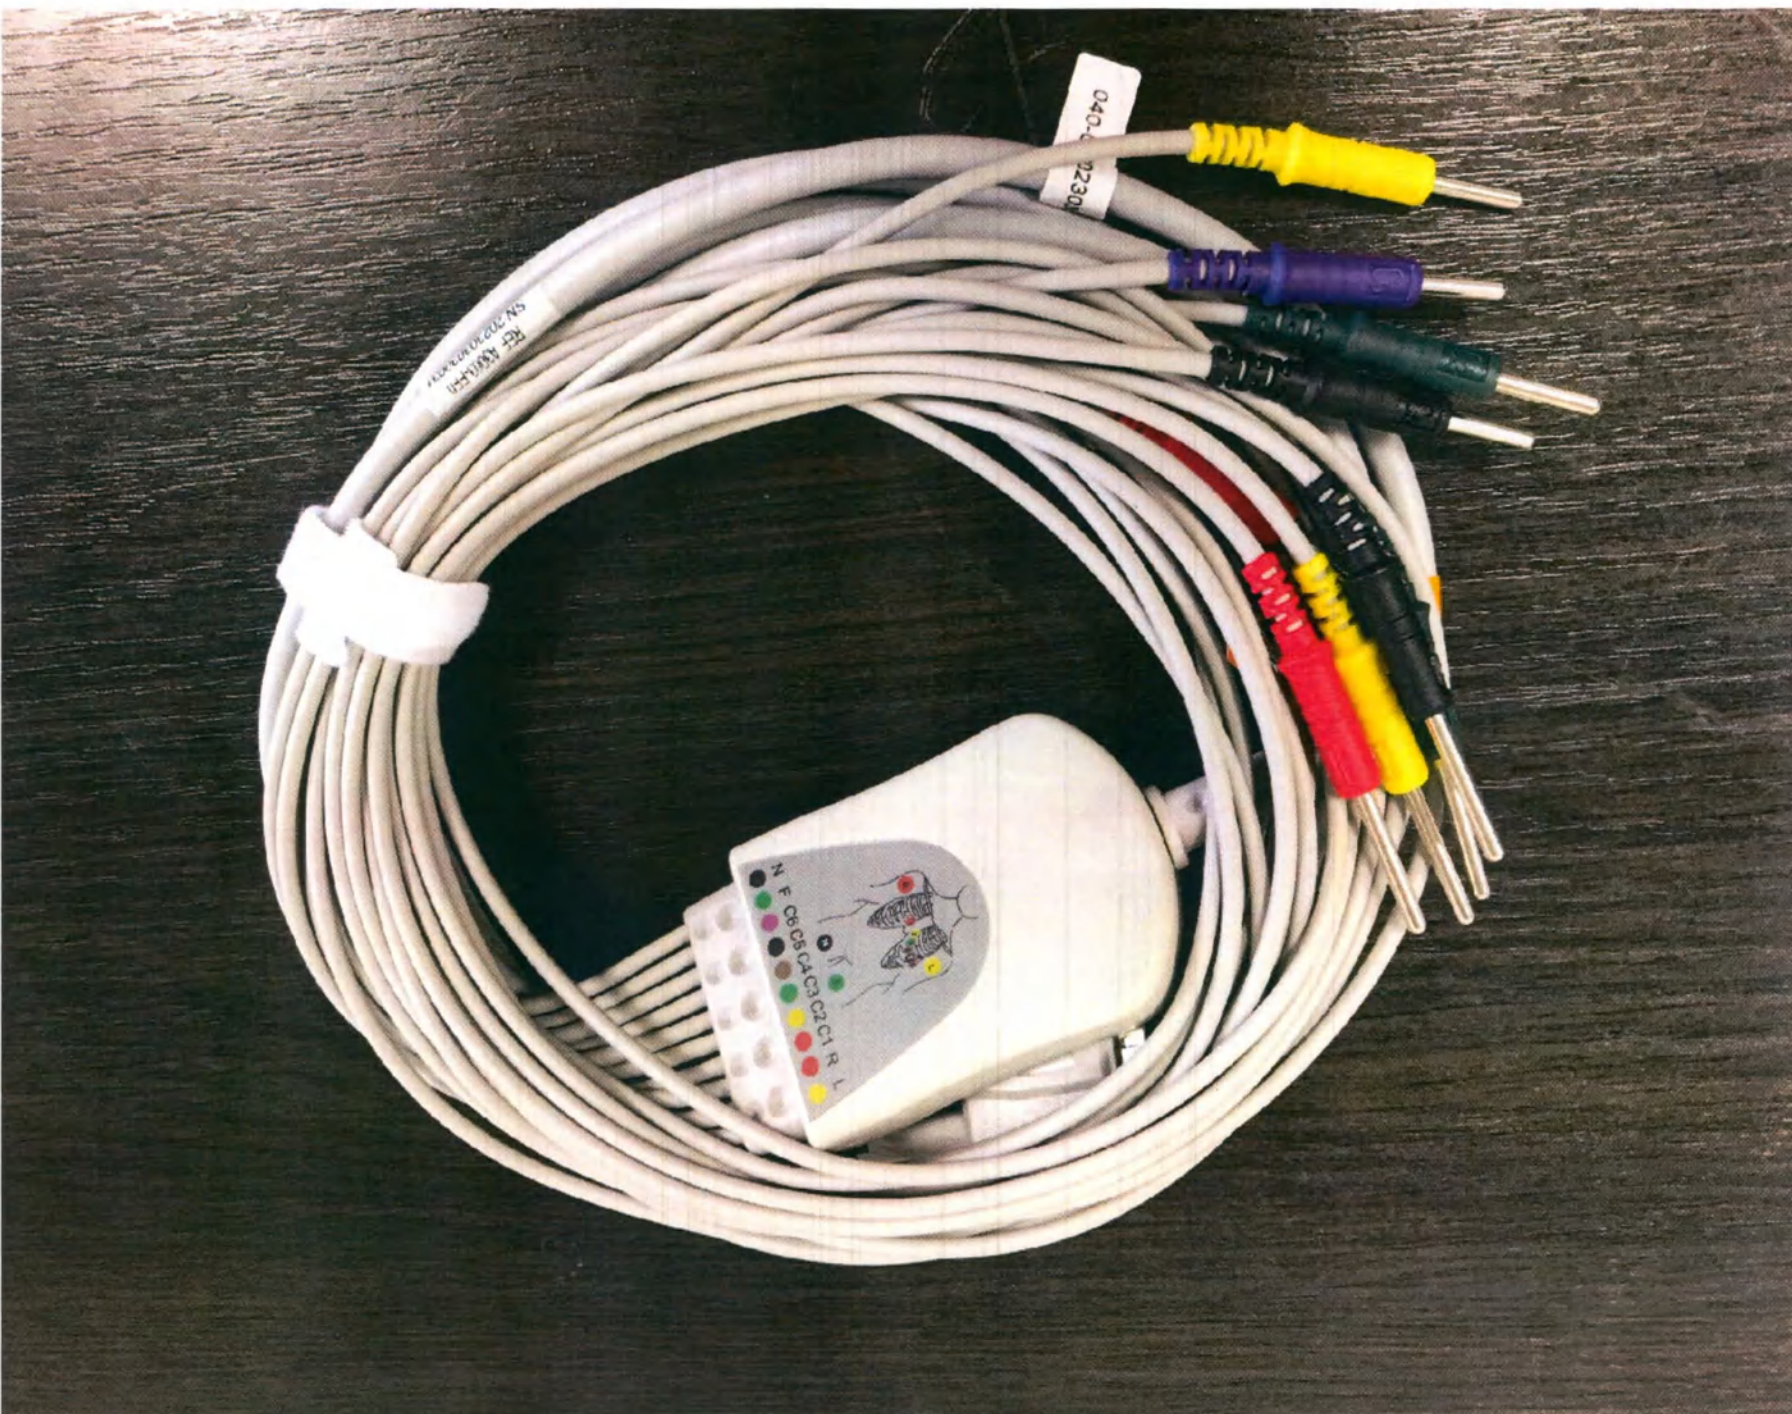

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (общий вид)

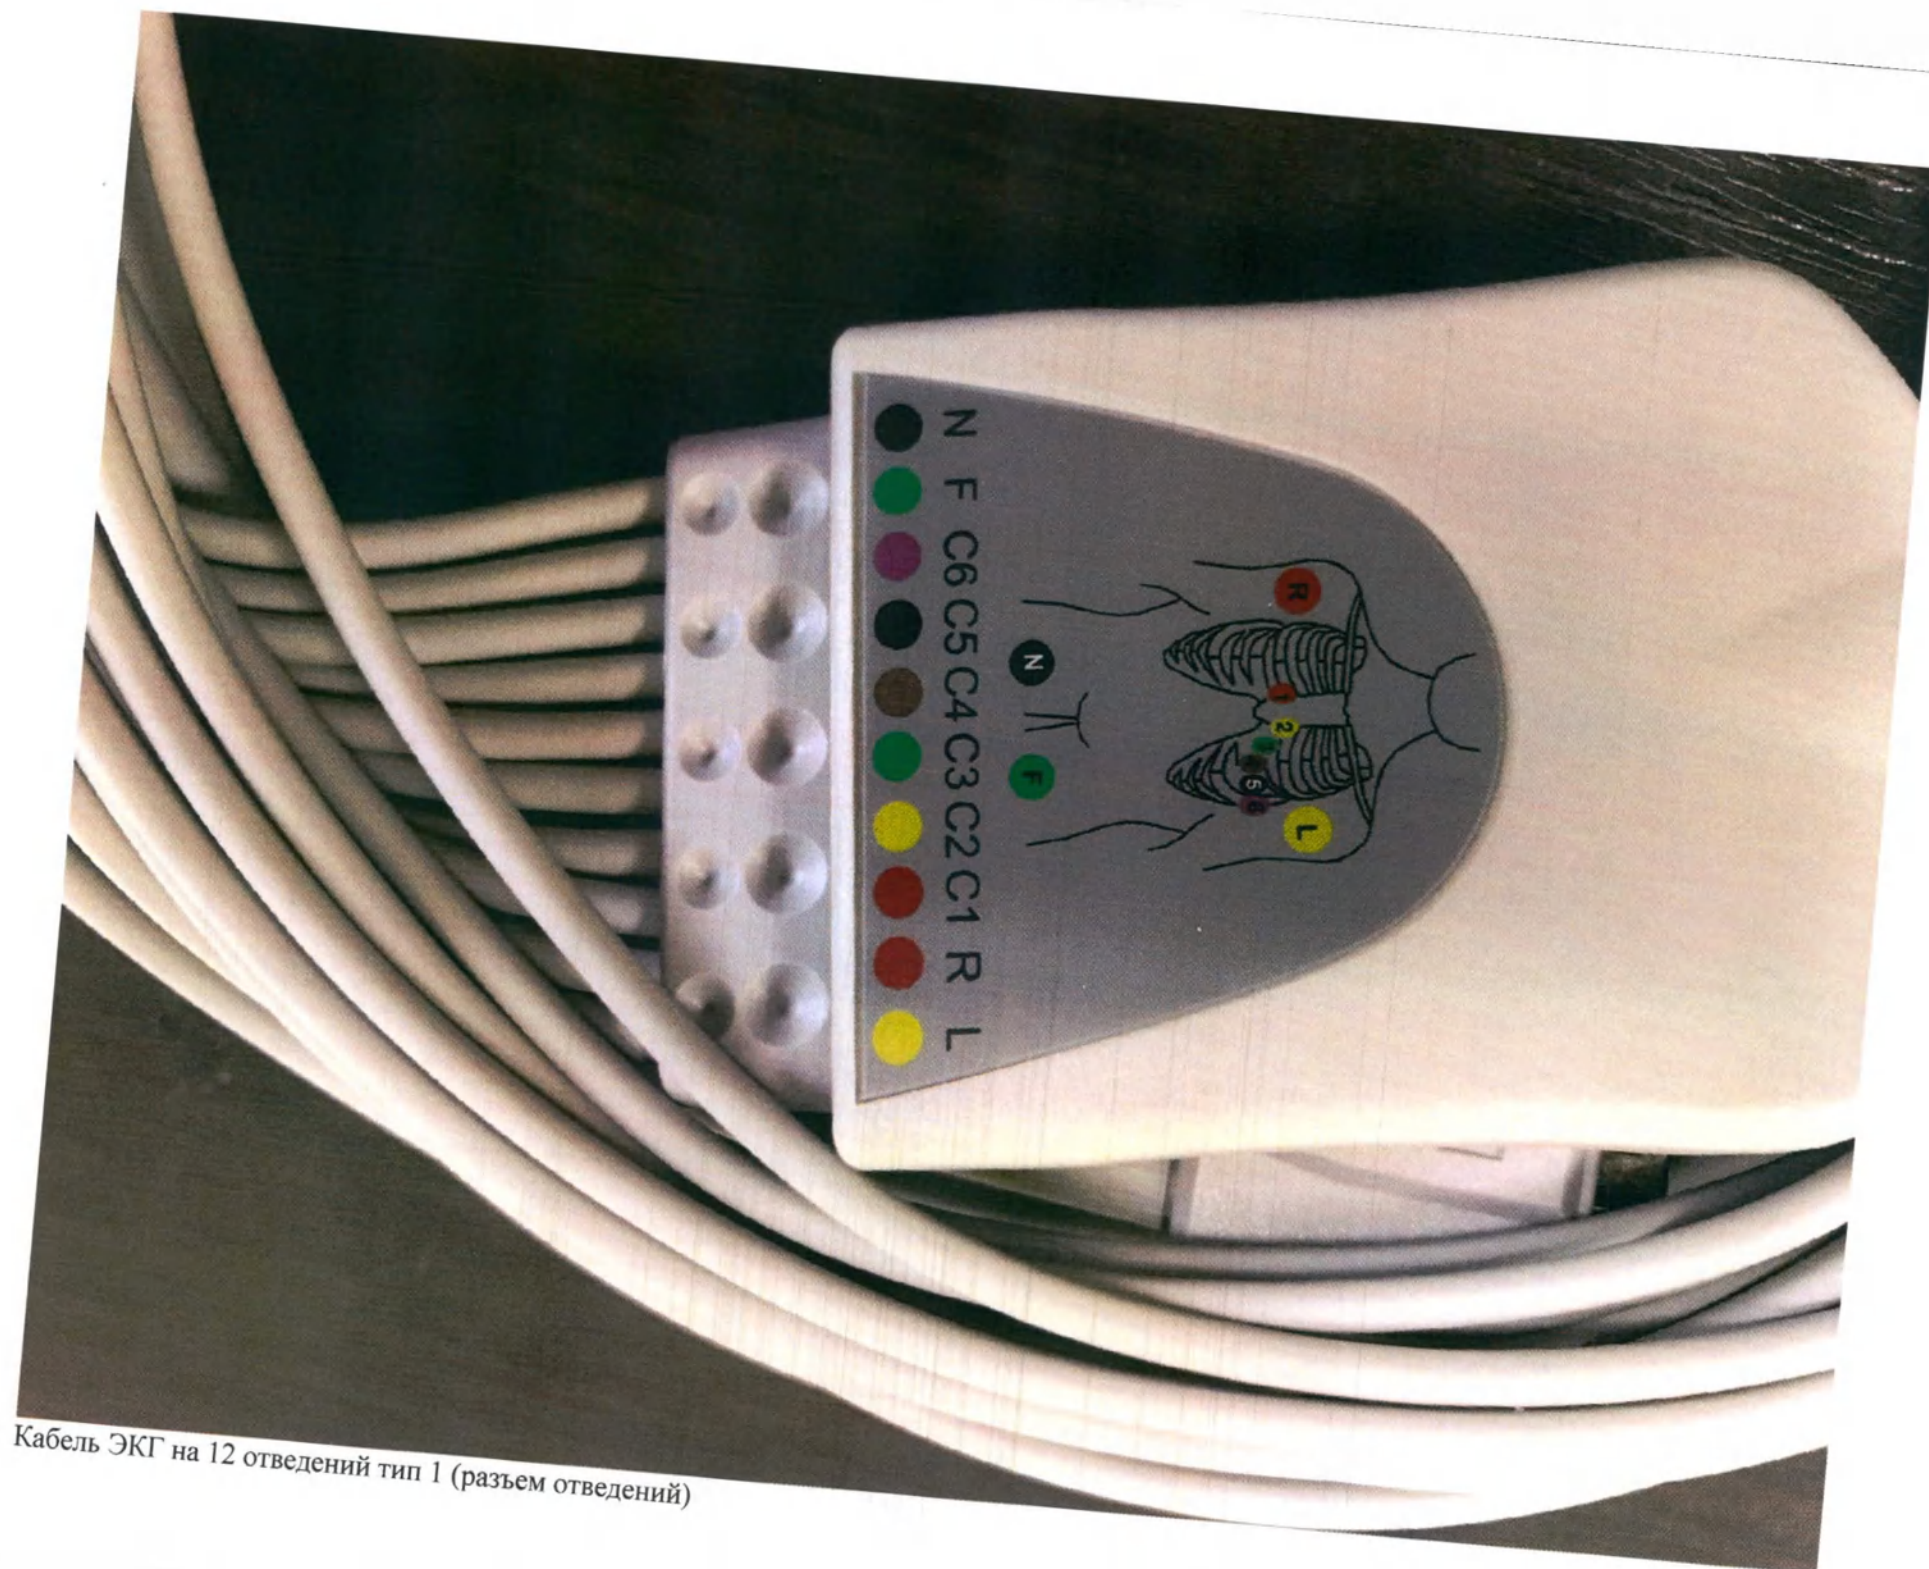


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (разъем отведений)

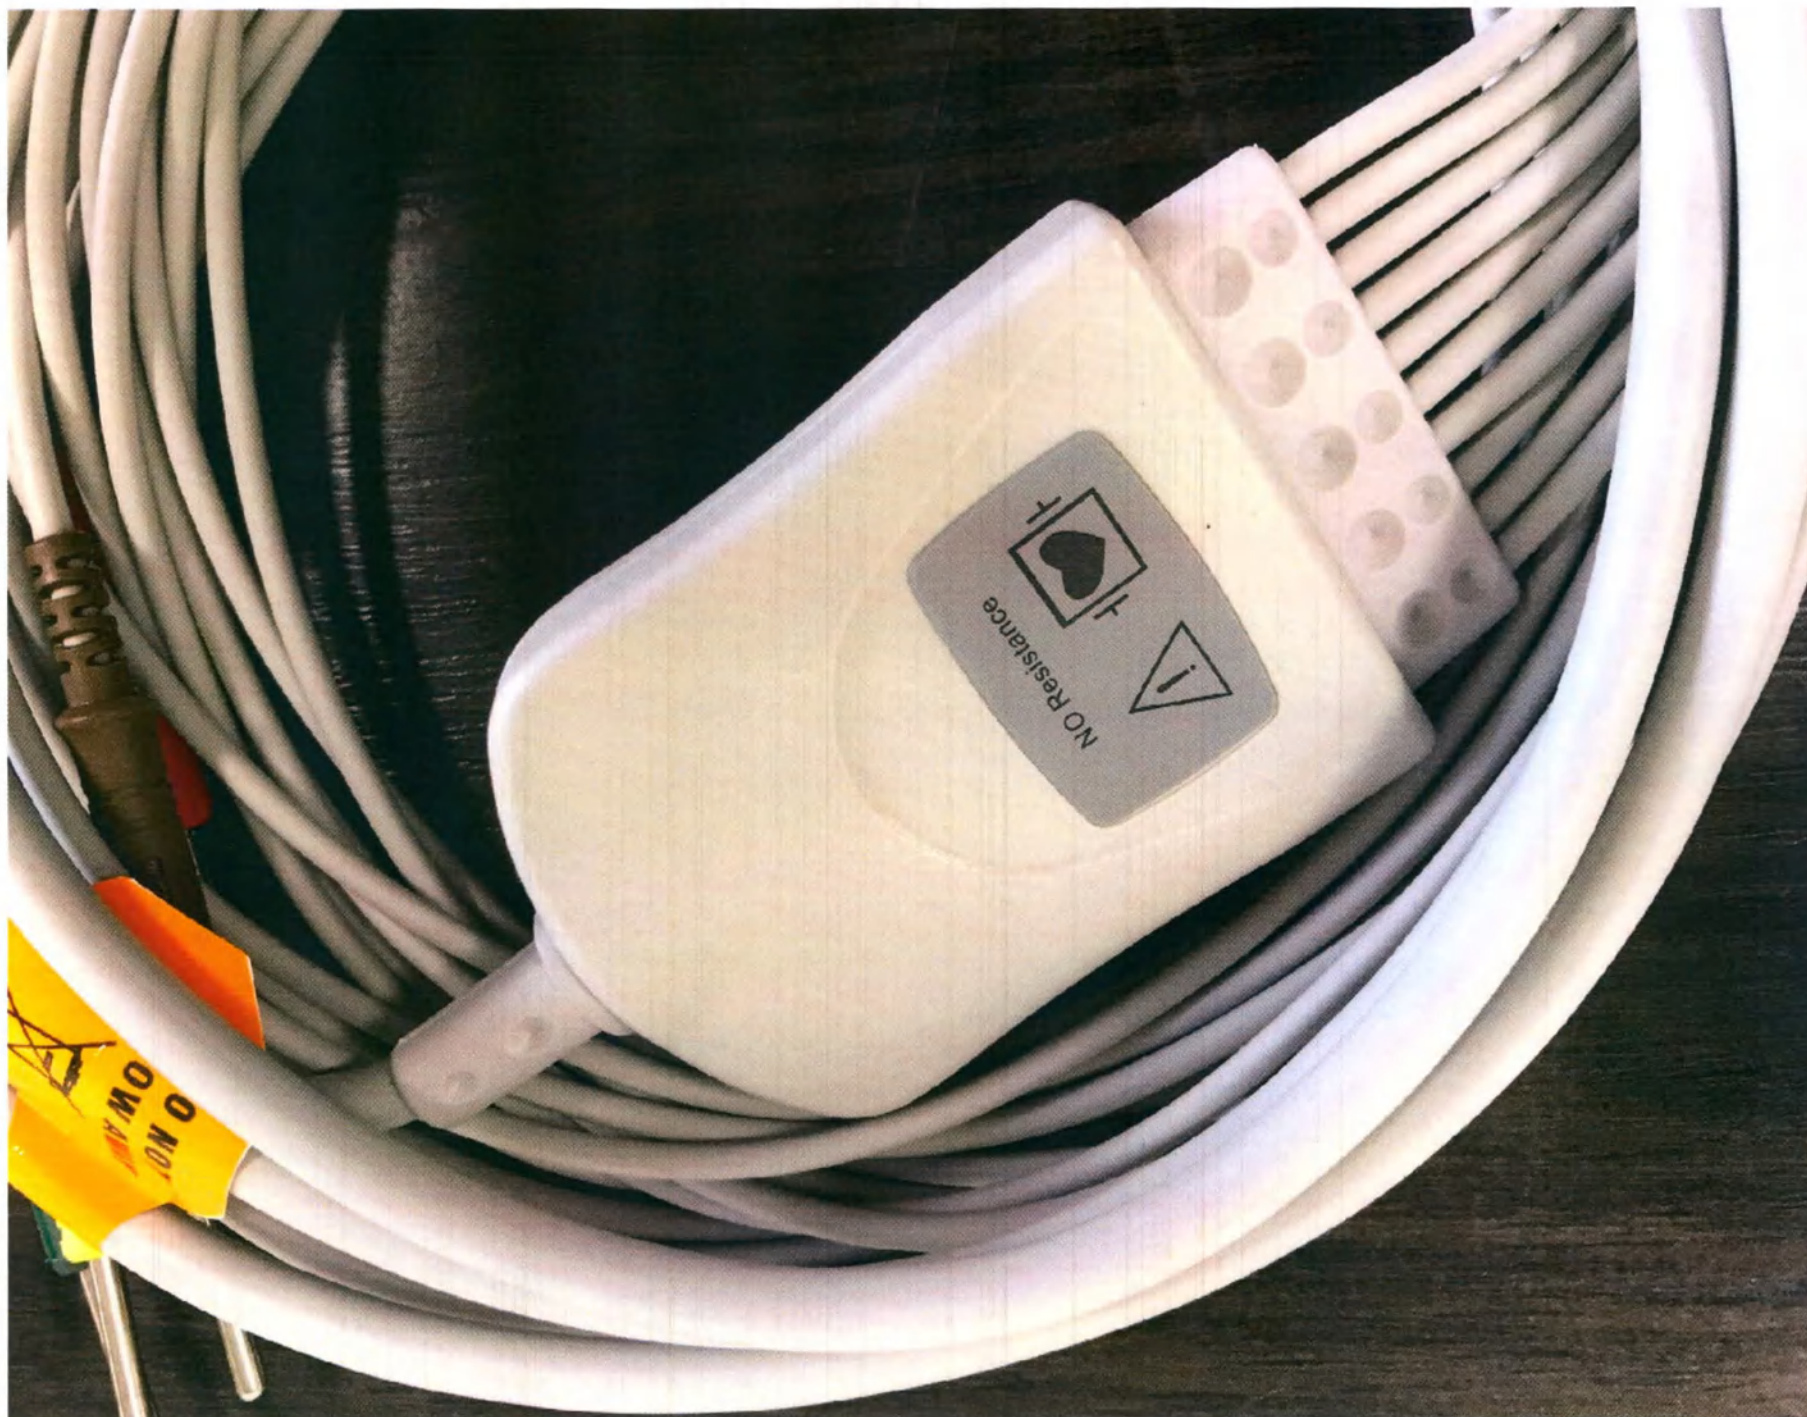


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (маркировка разъема отведений)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 1 (наклейка с серийным номером)

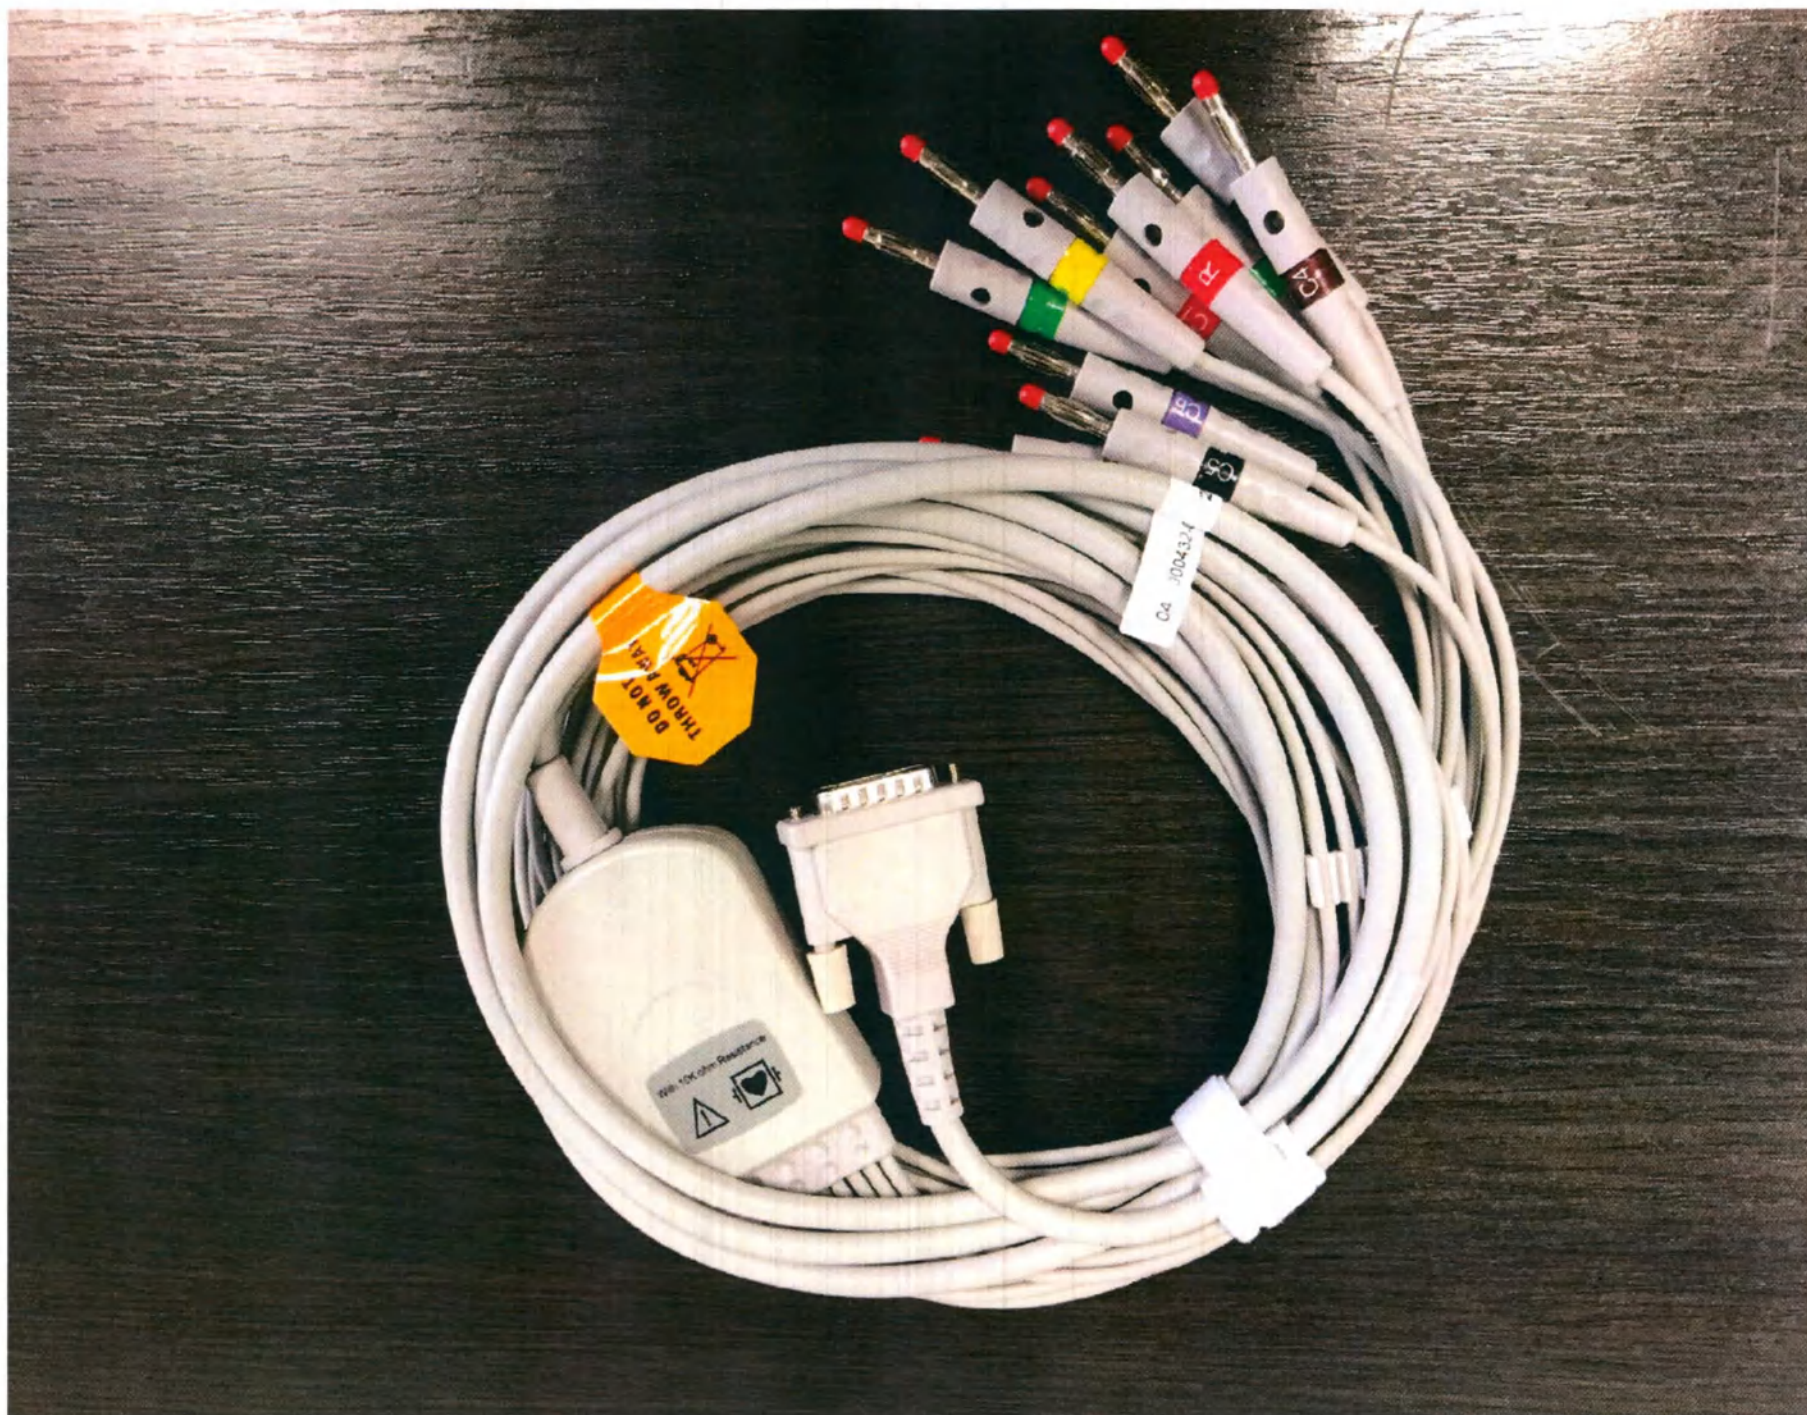

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (общий вид)

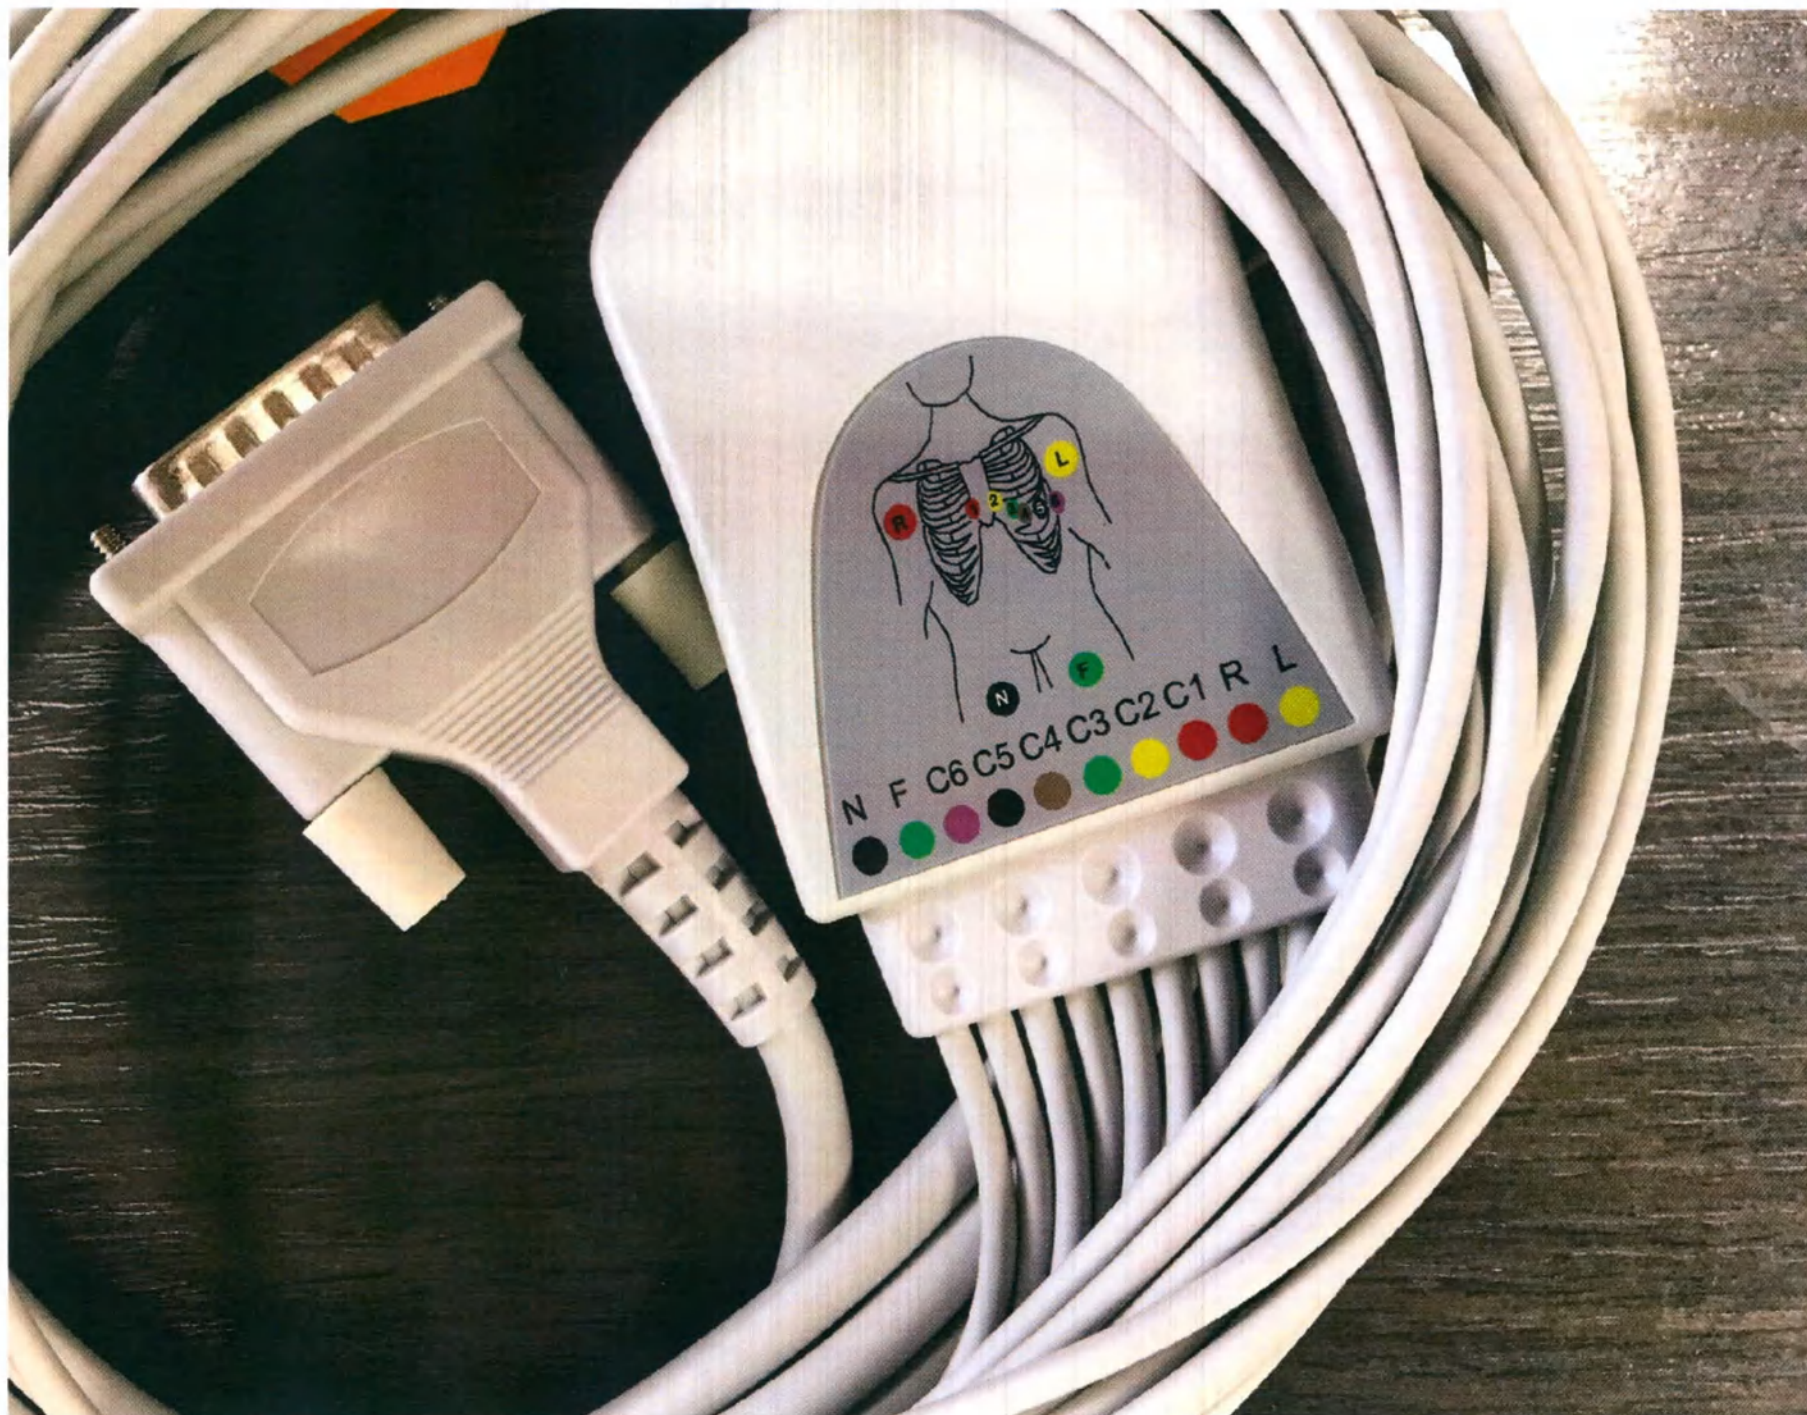


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (разъем отведений, маркировка)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 2 (наклейка с серийным номером)

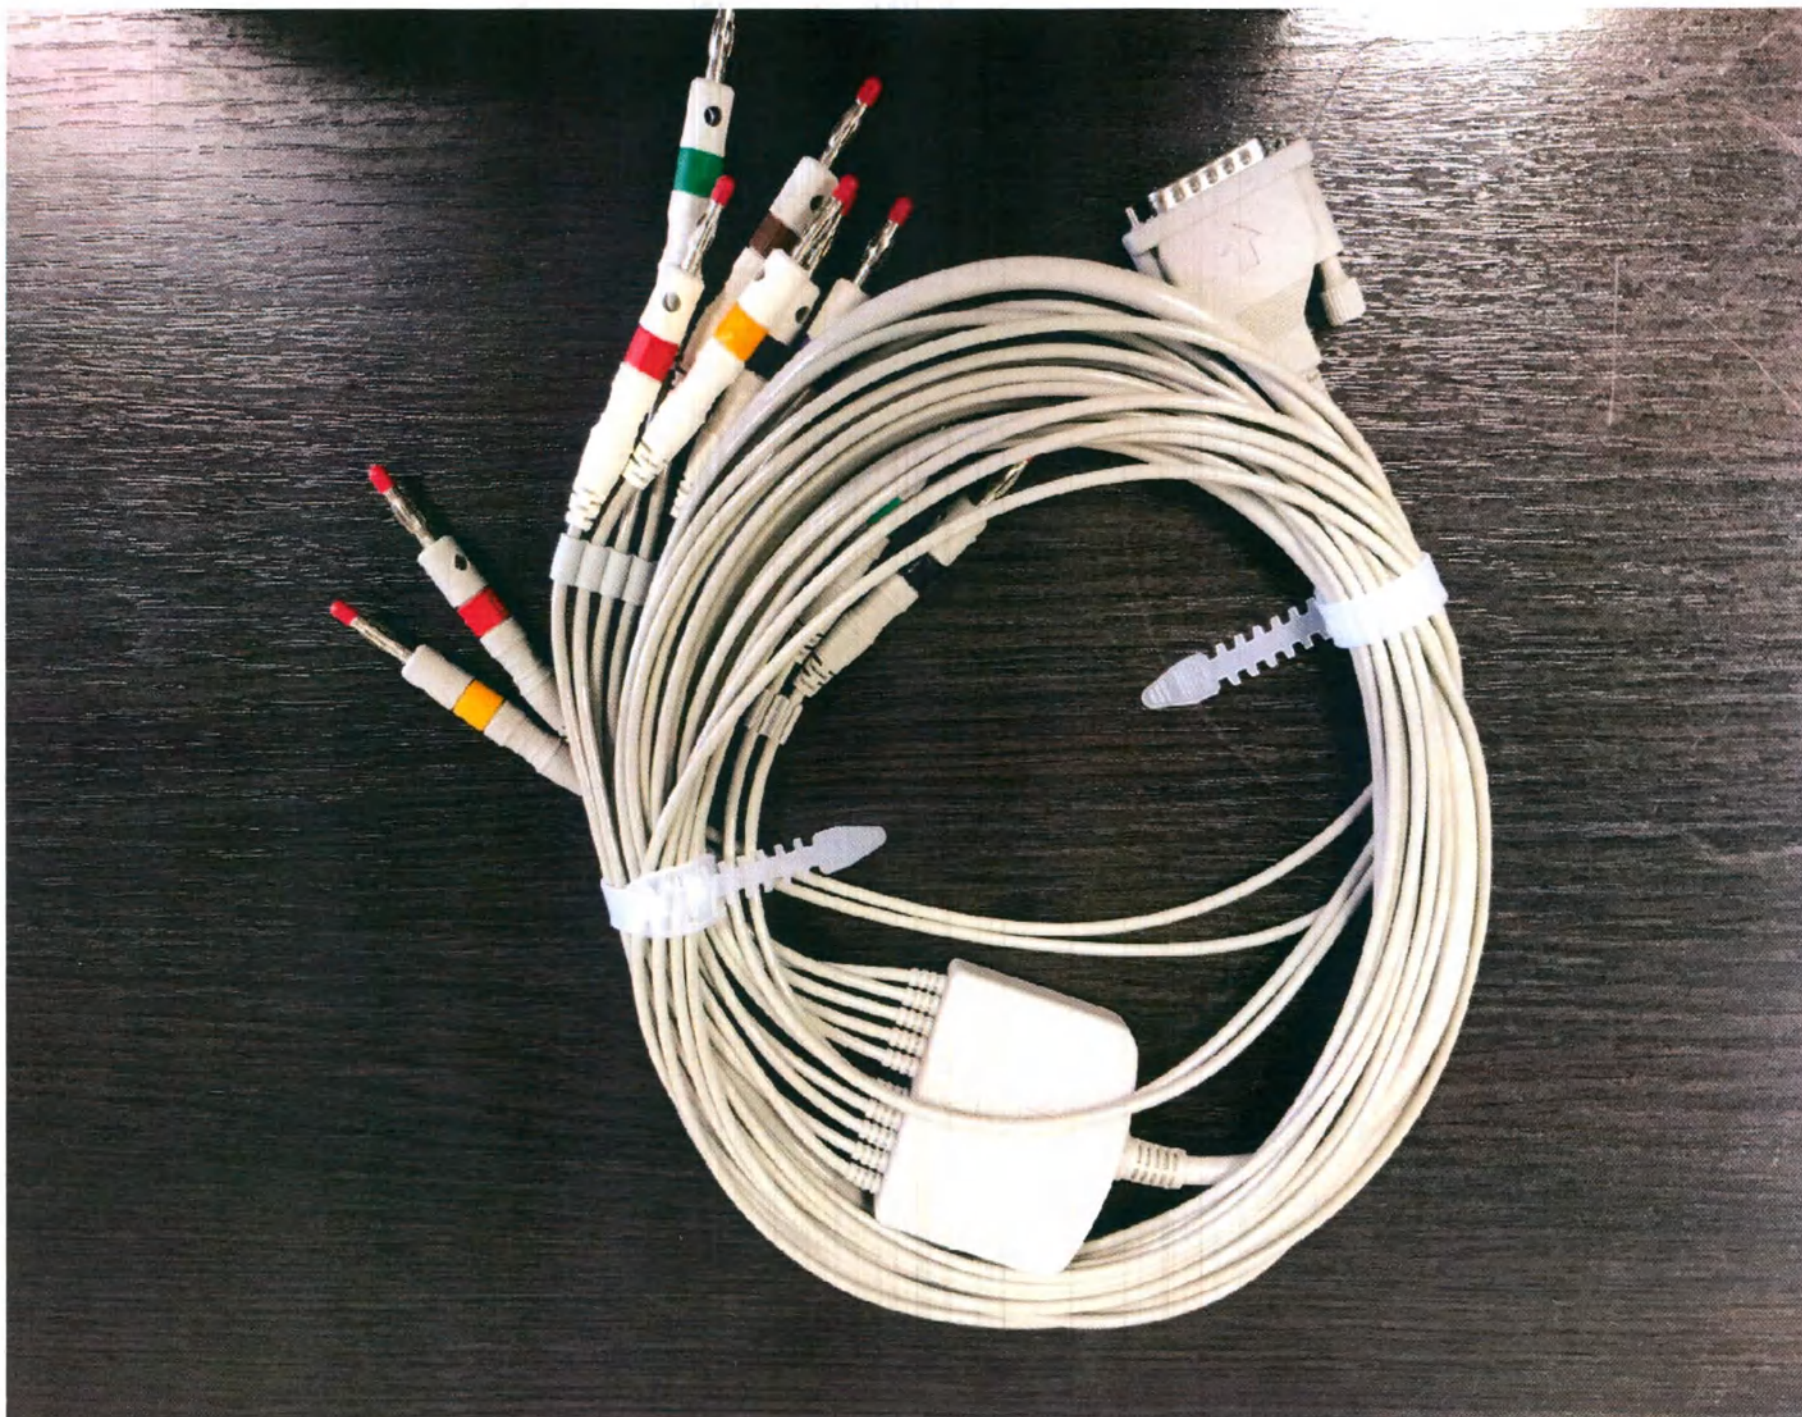

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (общий вид))

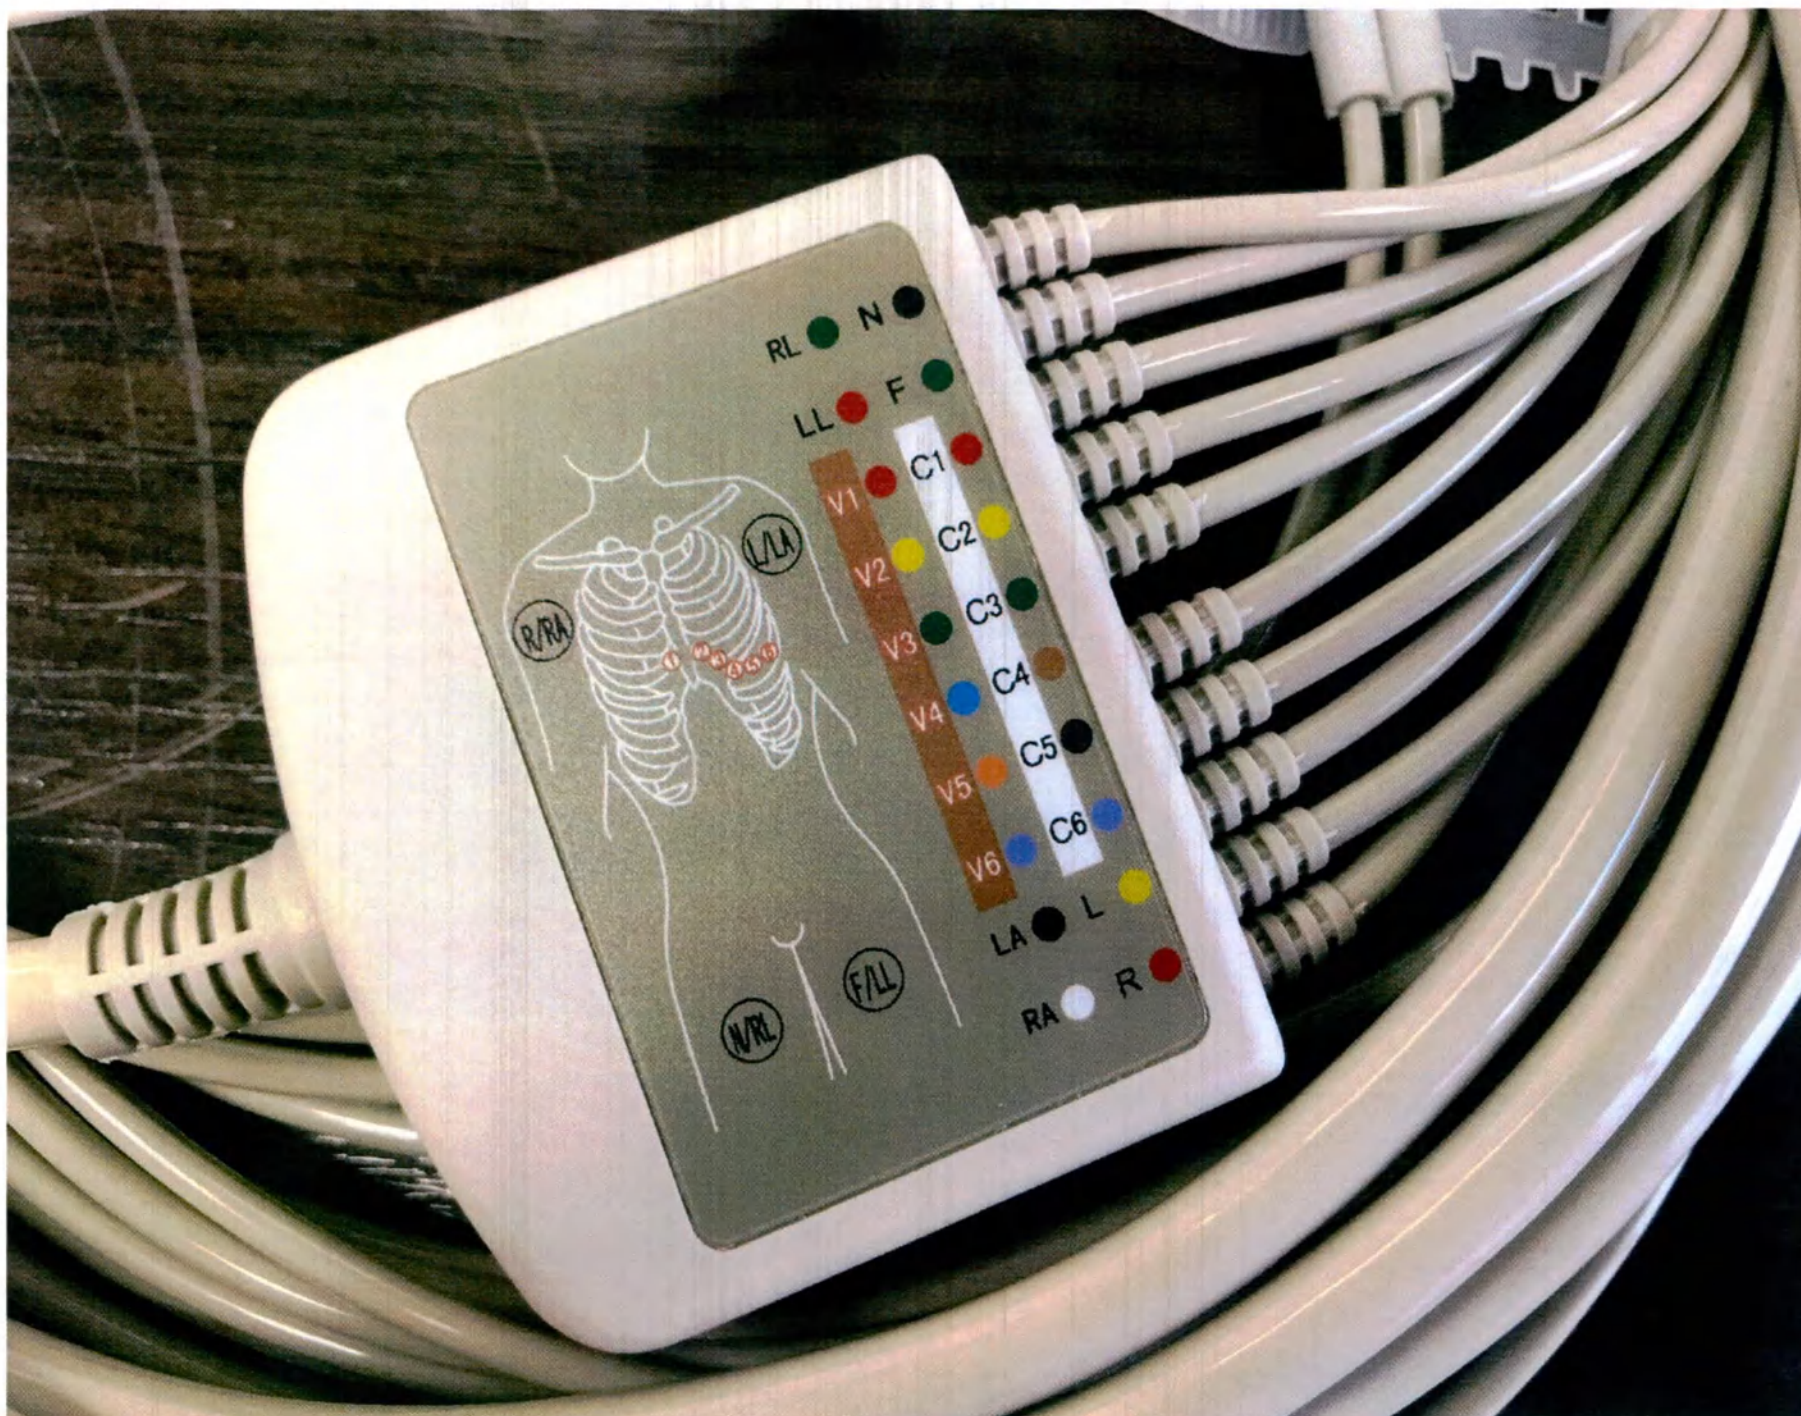


Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (разъем отведений)

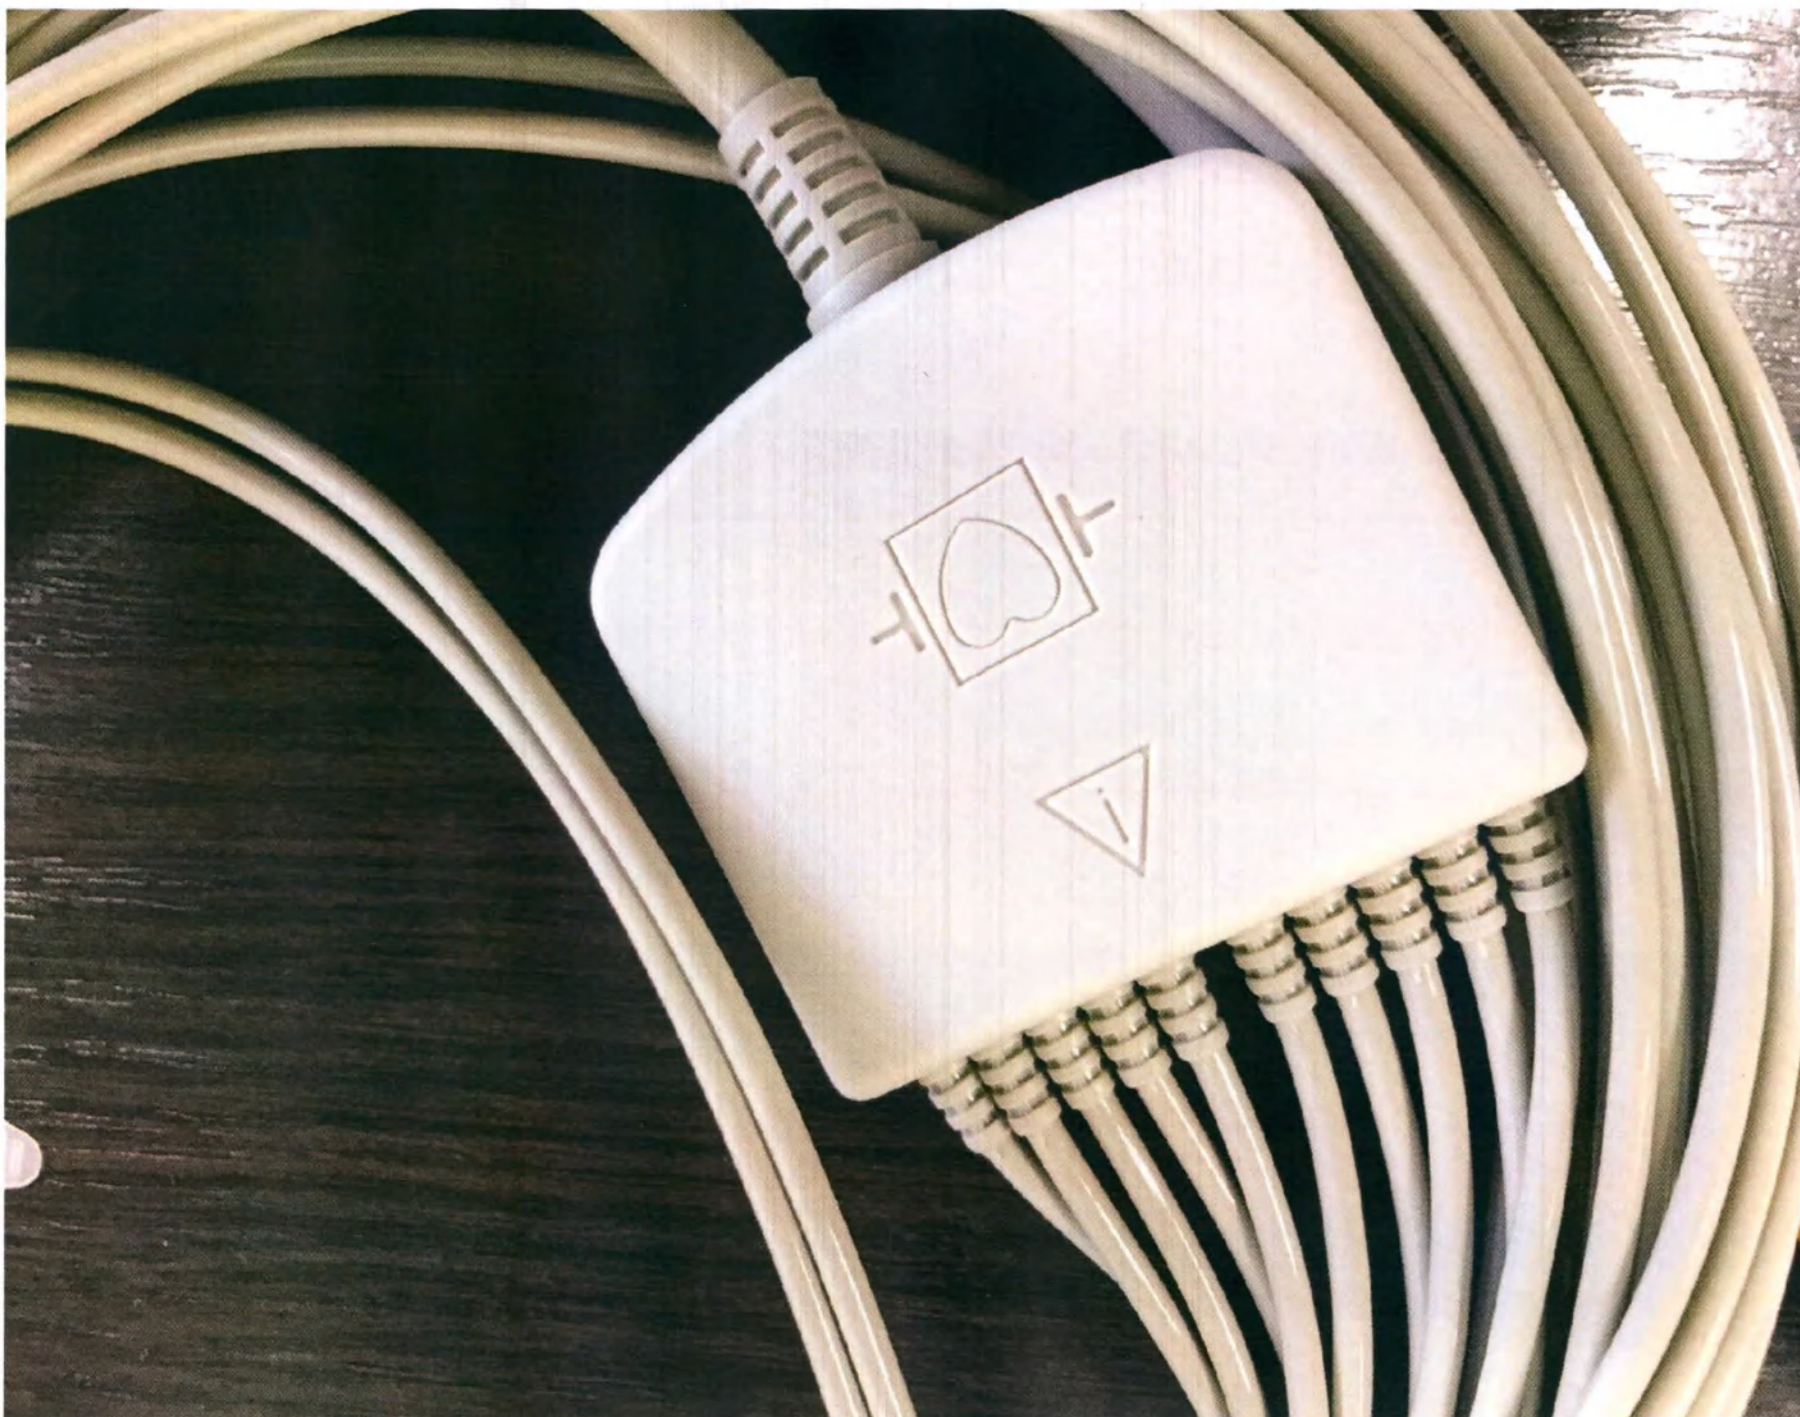

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (маркировка разъема отведений)




Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 3 (наклейка с серийным номером)

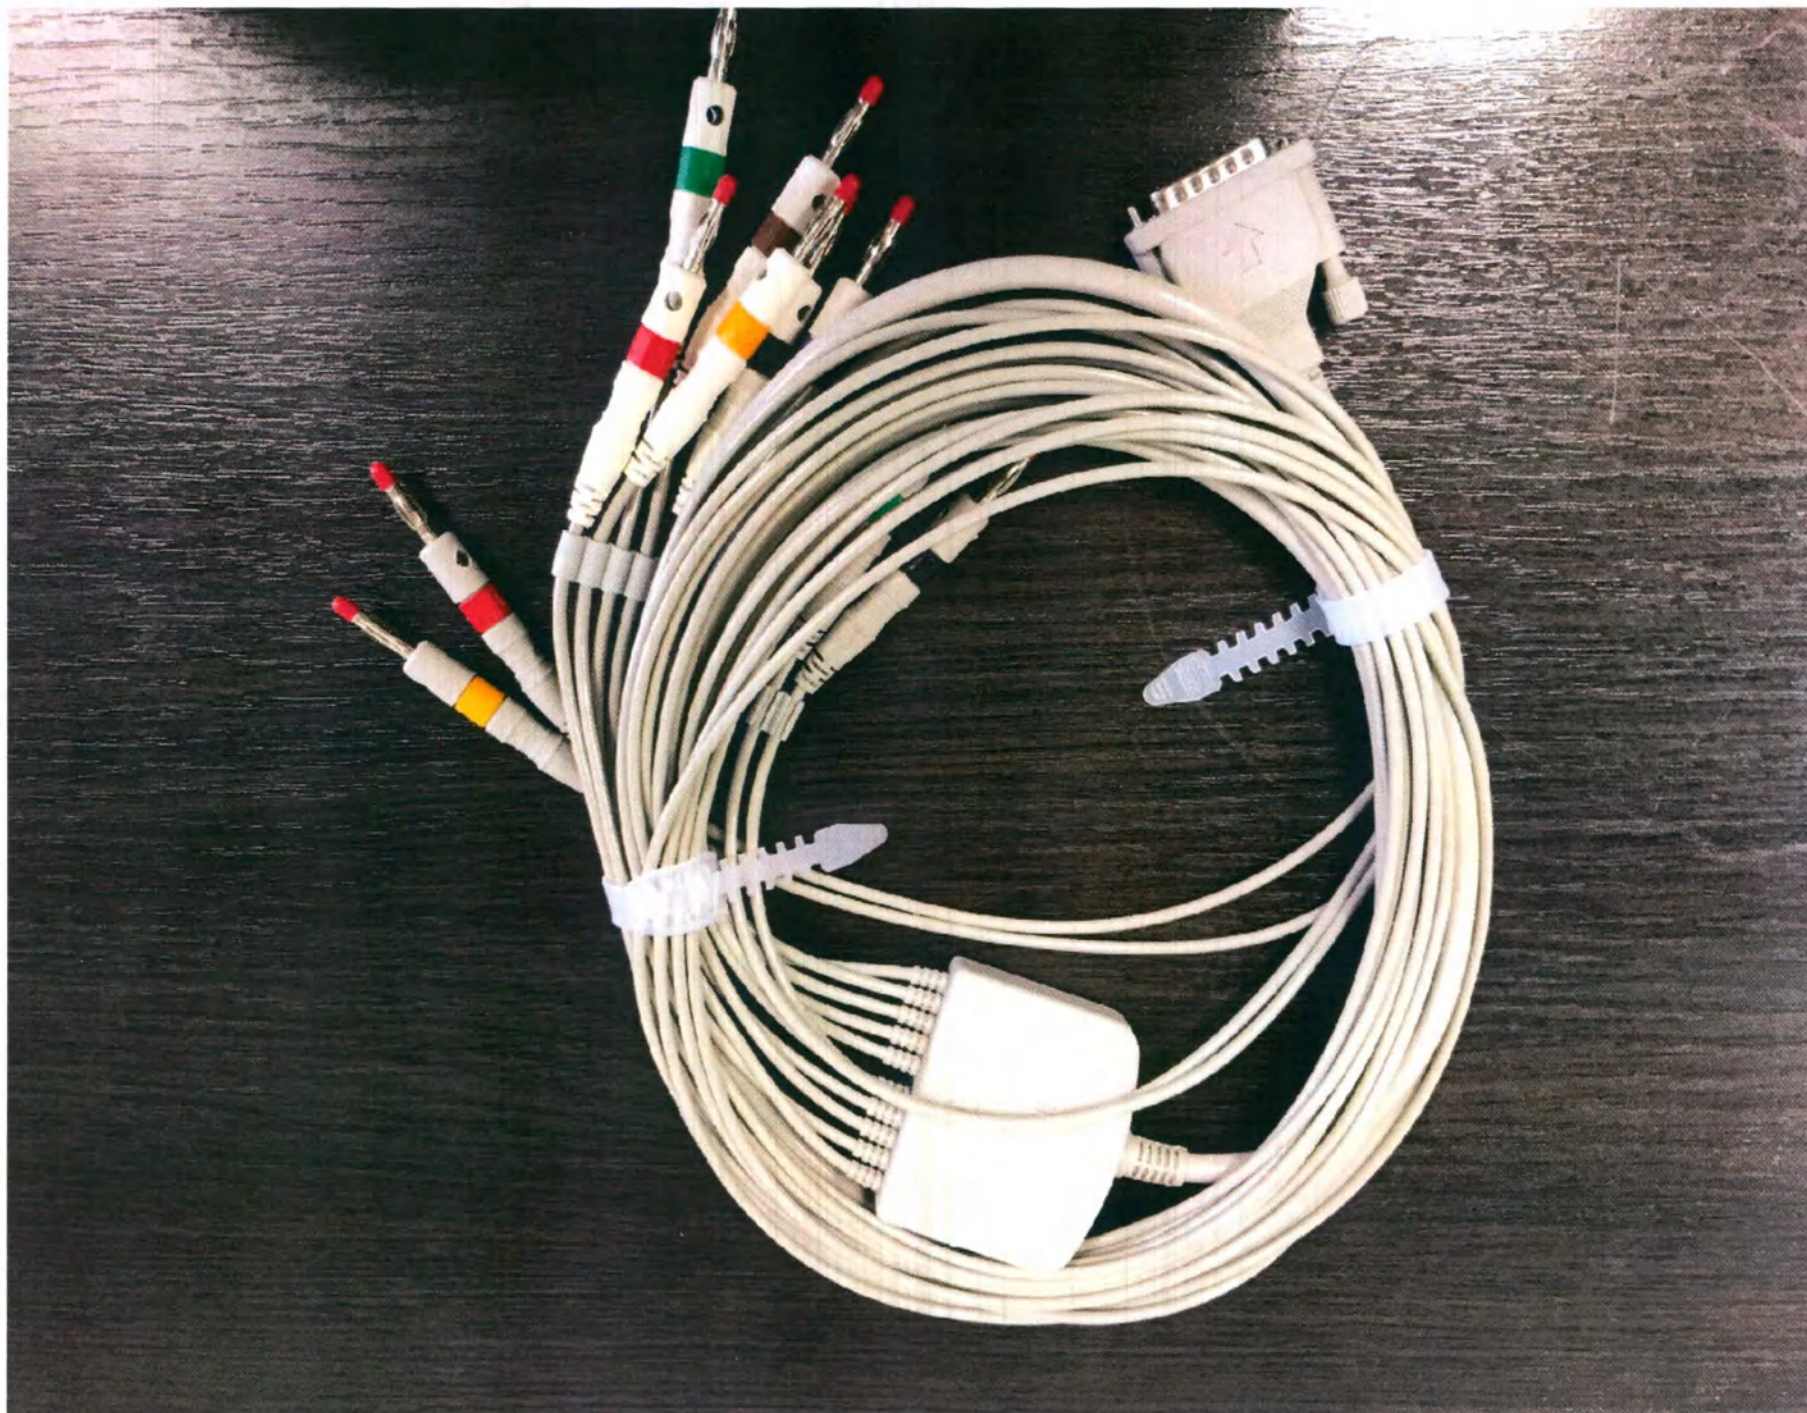

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (общий вид)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (разъем отведений)

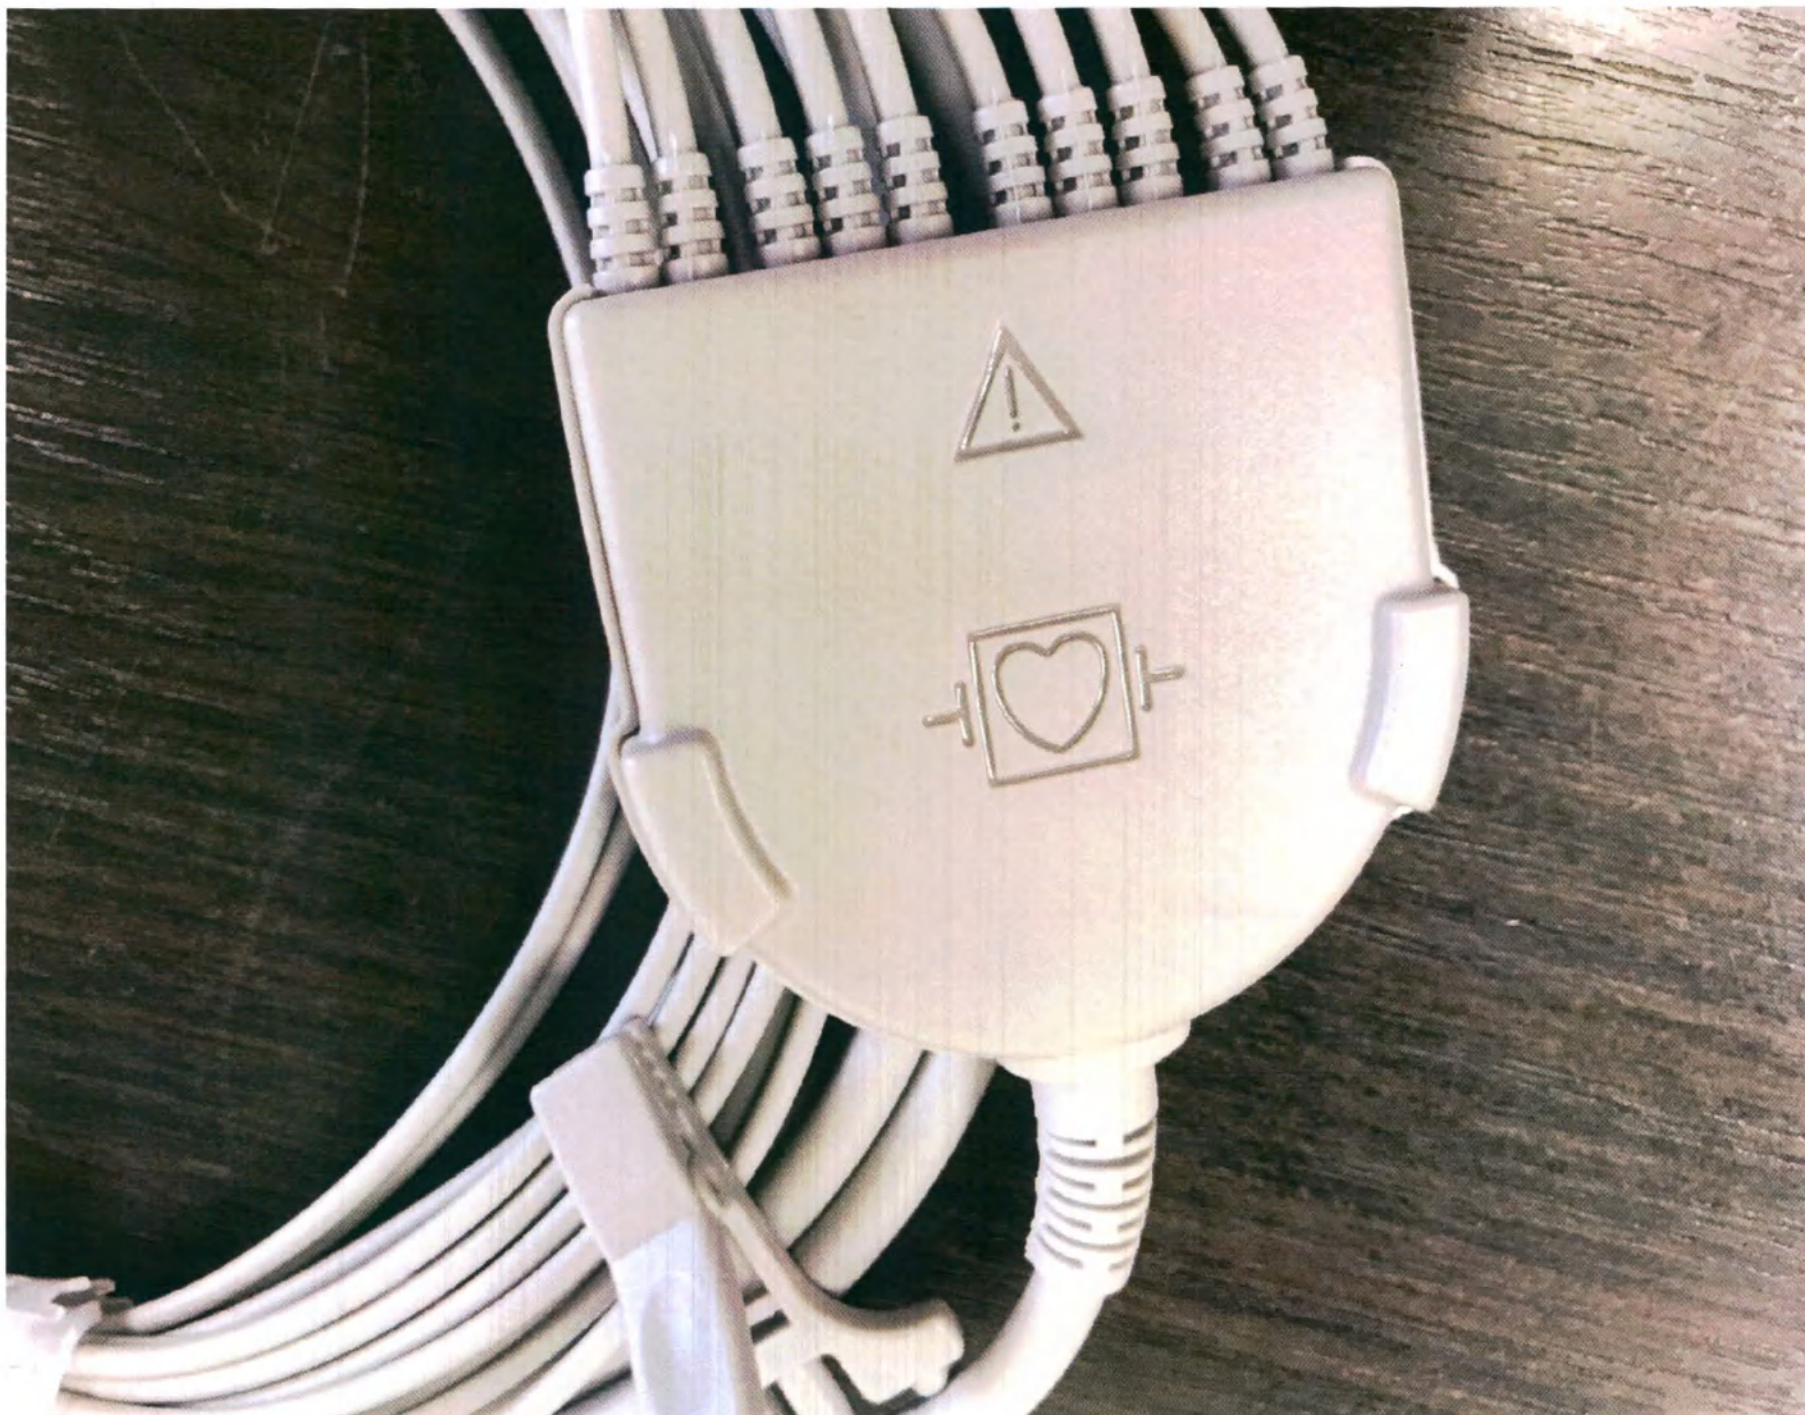

Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (маркировка разъема отведений)



Кабель ЭКГ на 12 отведений тип 4 (наклейка с серийным номером)



Электрод-клипса для детей (в упаковке)



Электрод-клипса для детей (общий вид)




Электрод-клипса для детей (общий вид сбоку)



LOT ZH22040452211250029

 25.11.2022

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 1
Количество в упаковке – 4 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид)

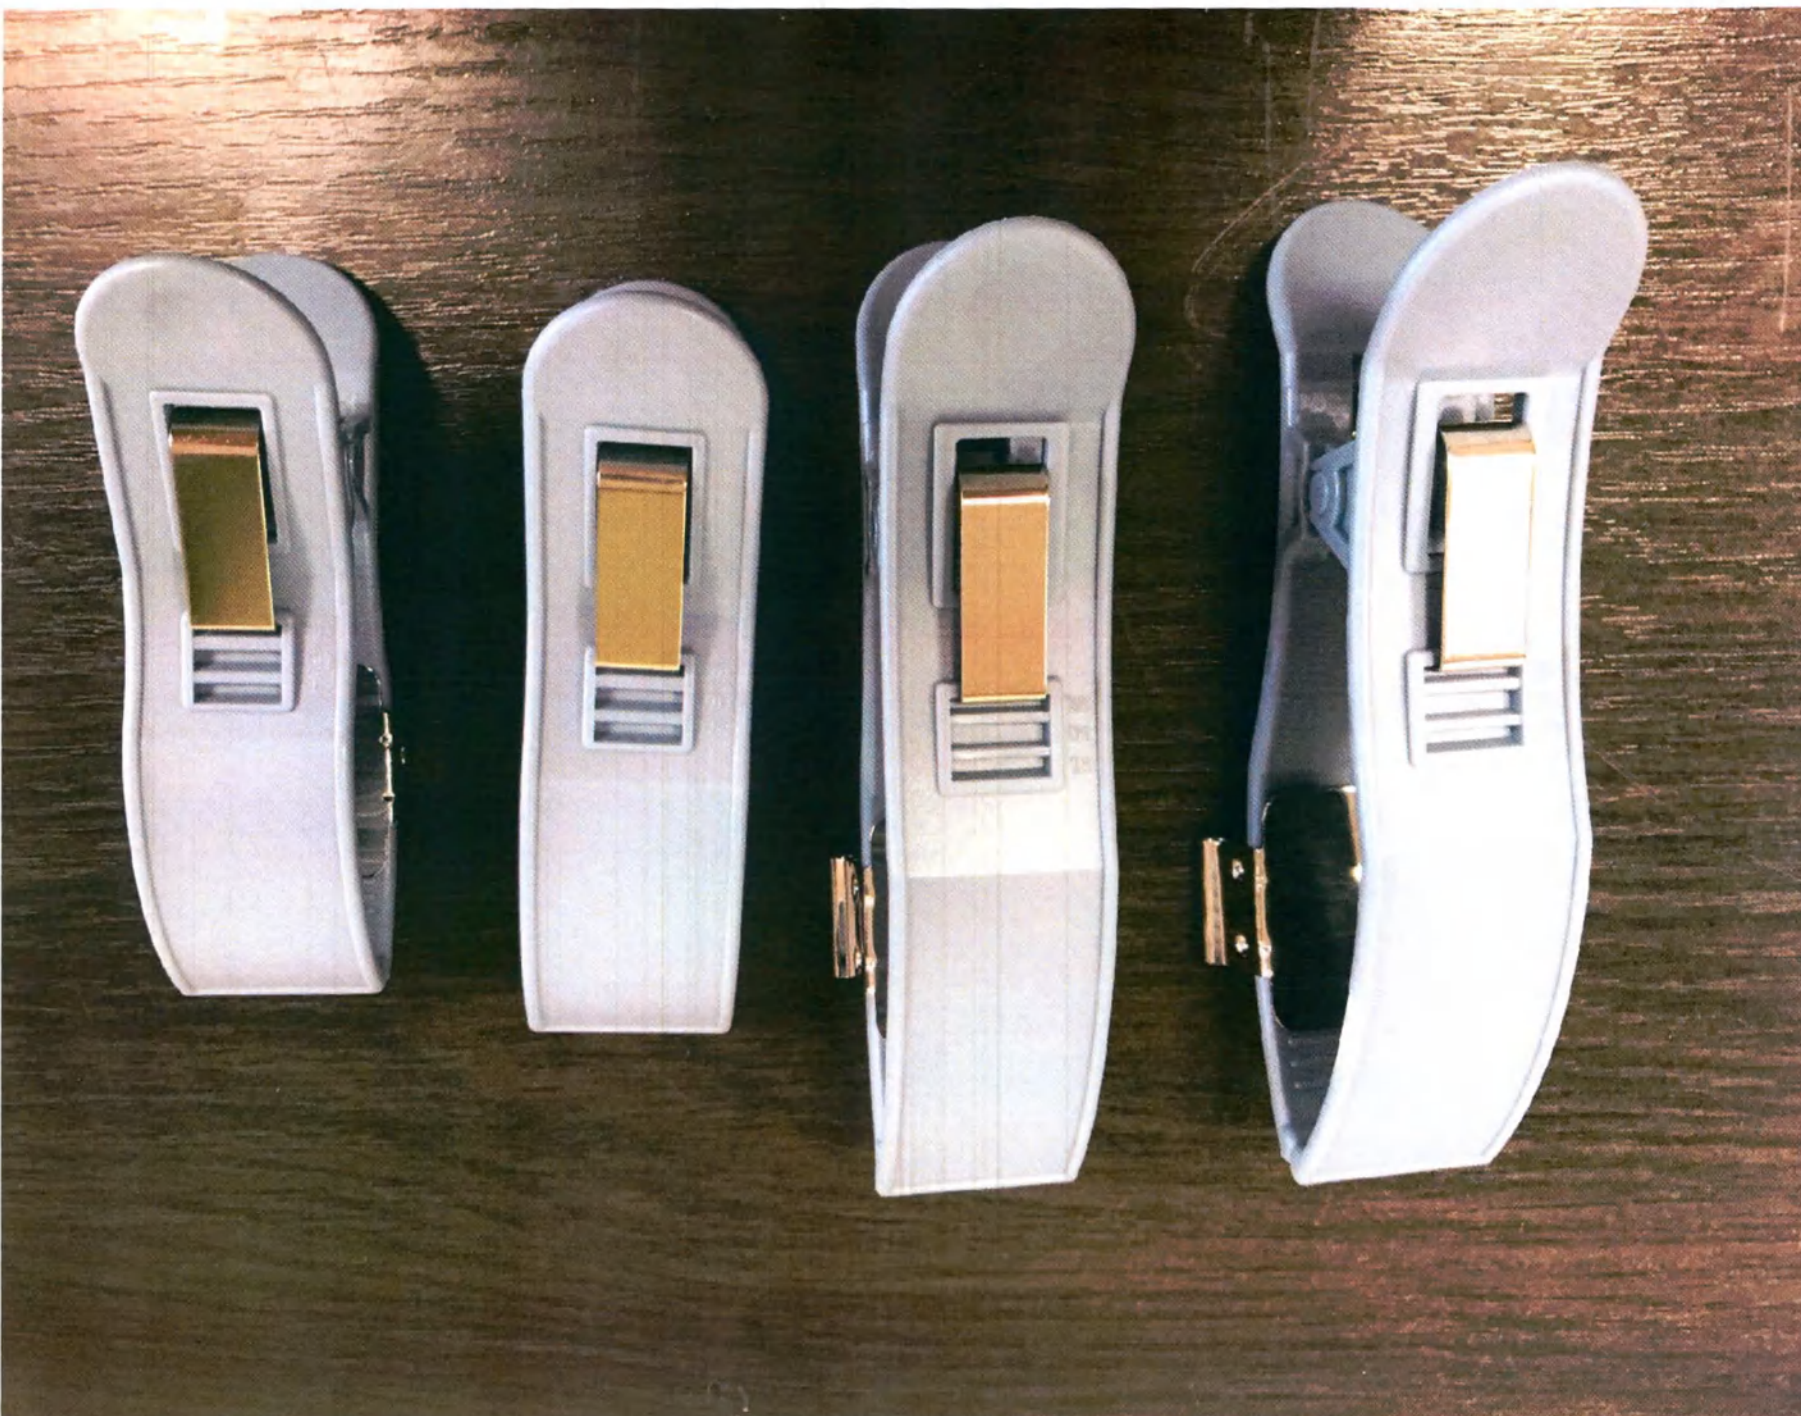


Электрод-клипса для взрослых тип 1 (общий вид сбоку)



LOT 20230222-866

 22.02.2023

COMEN



Электрод-клипса для взрослых тип 2
Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,
ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.
Регистрационное удостоверение №

Электрод-клипса для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-клипса для взрослых тип 2 (общий вид)




Электрод-груша для детей (в упаковке)



Электрод-груша для детей (упаковка)



Электрод-груша для детей (общий вид)

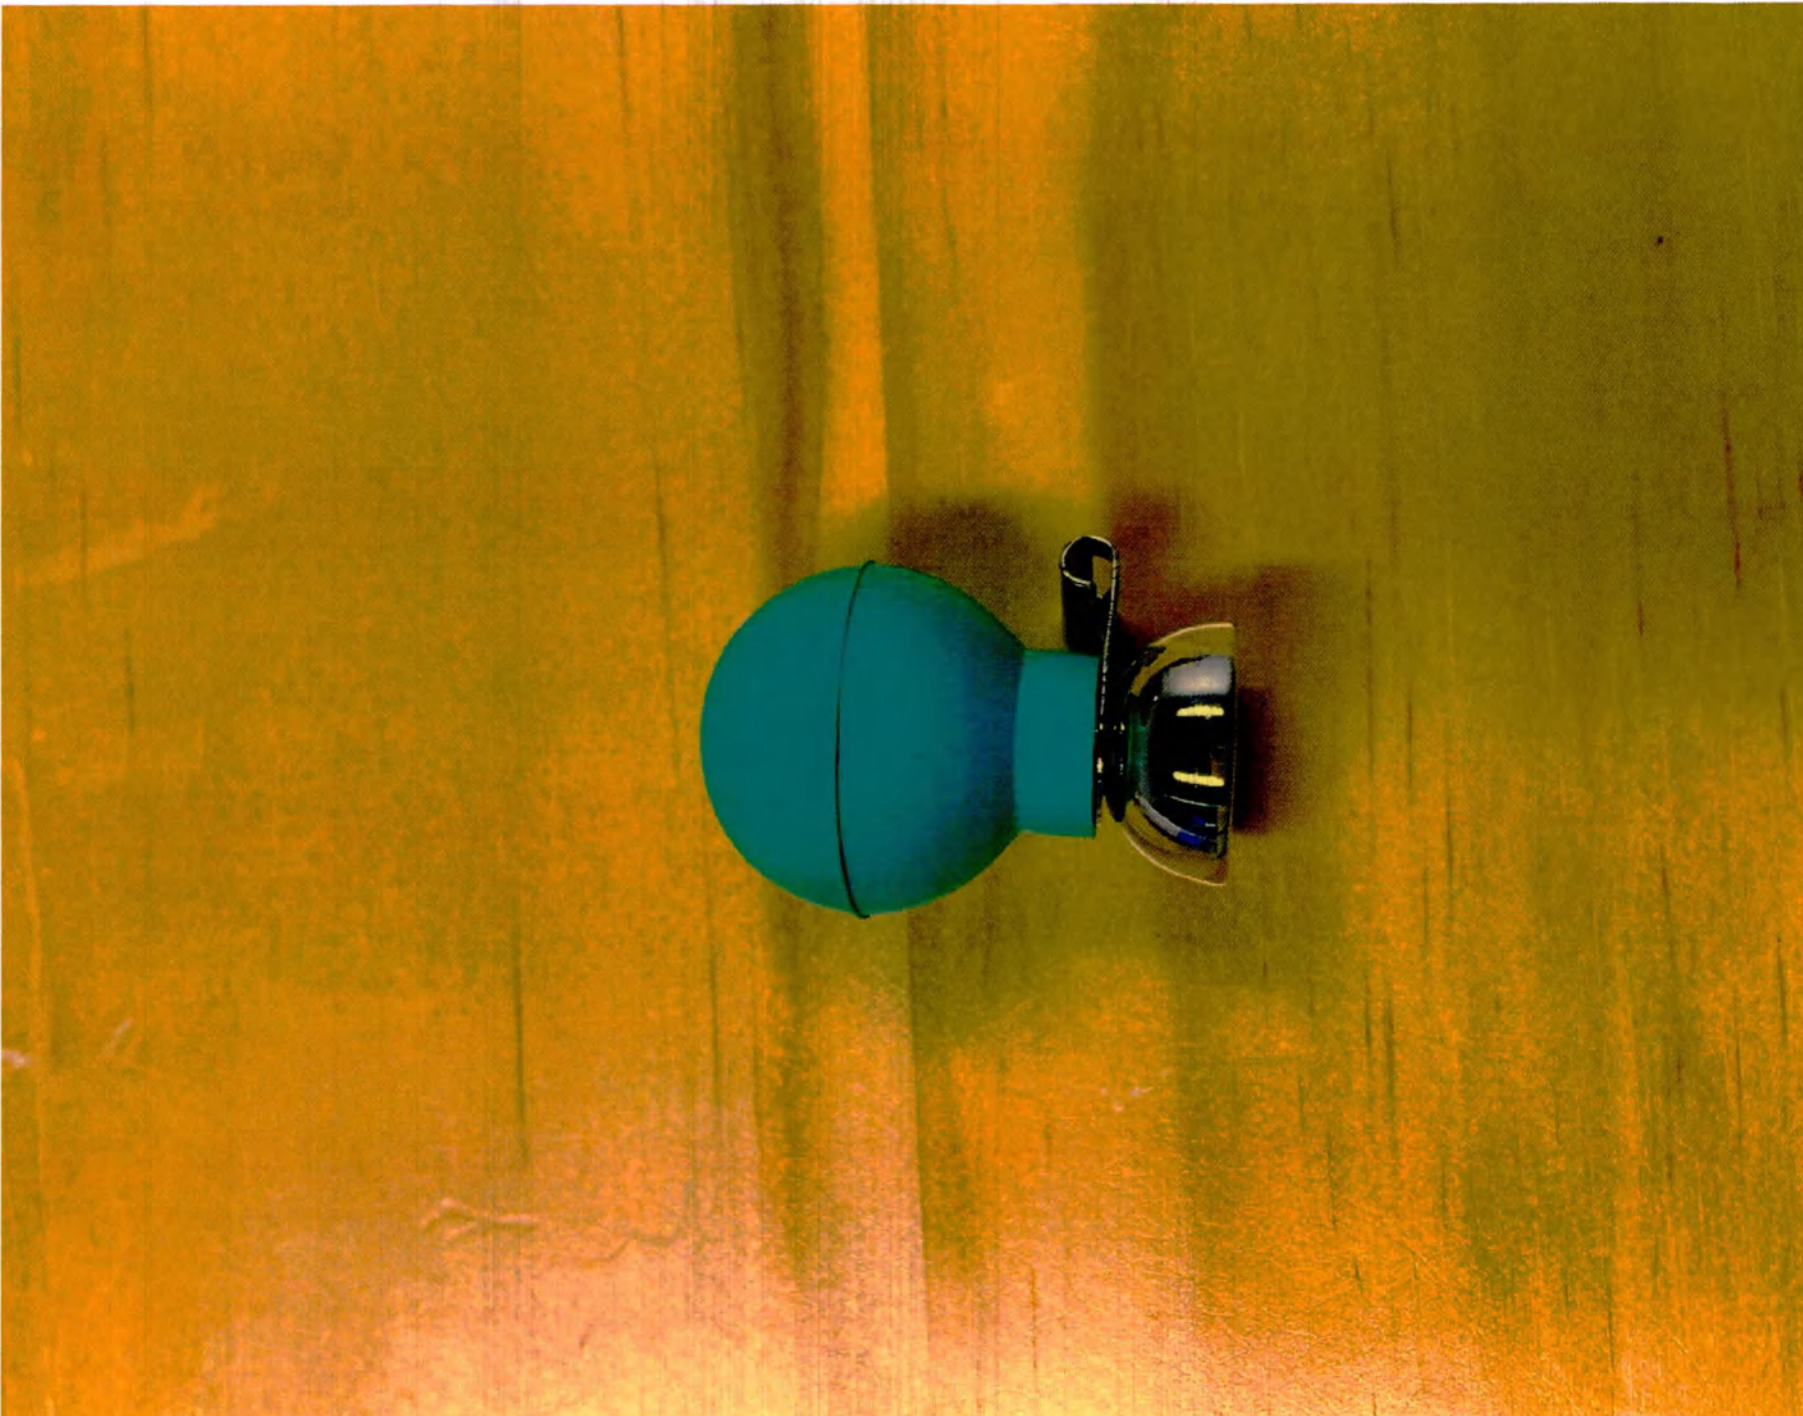


Электрод-груша для детей (общий вид)




Электрод-груша для взрослых тип 1 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 1 (общий вид)

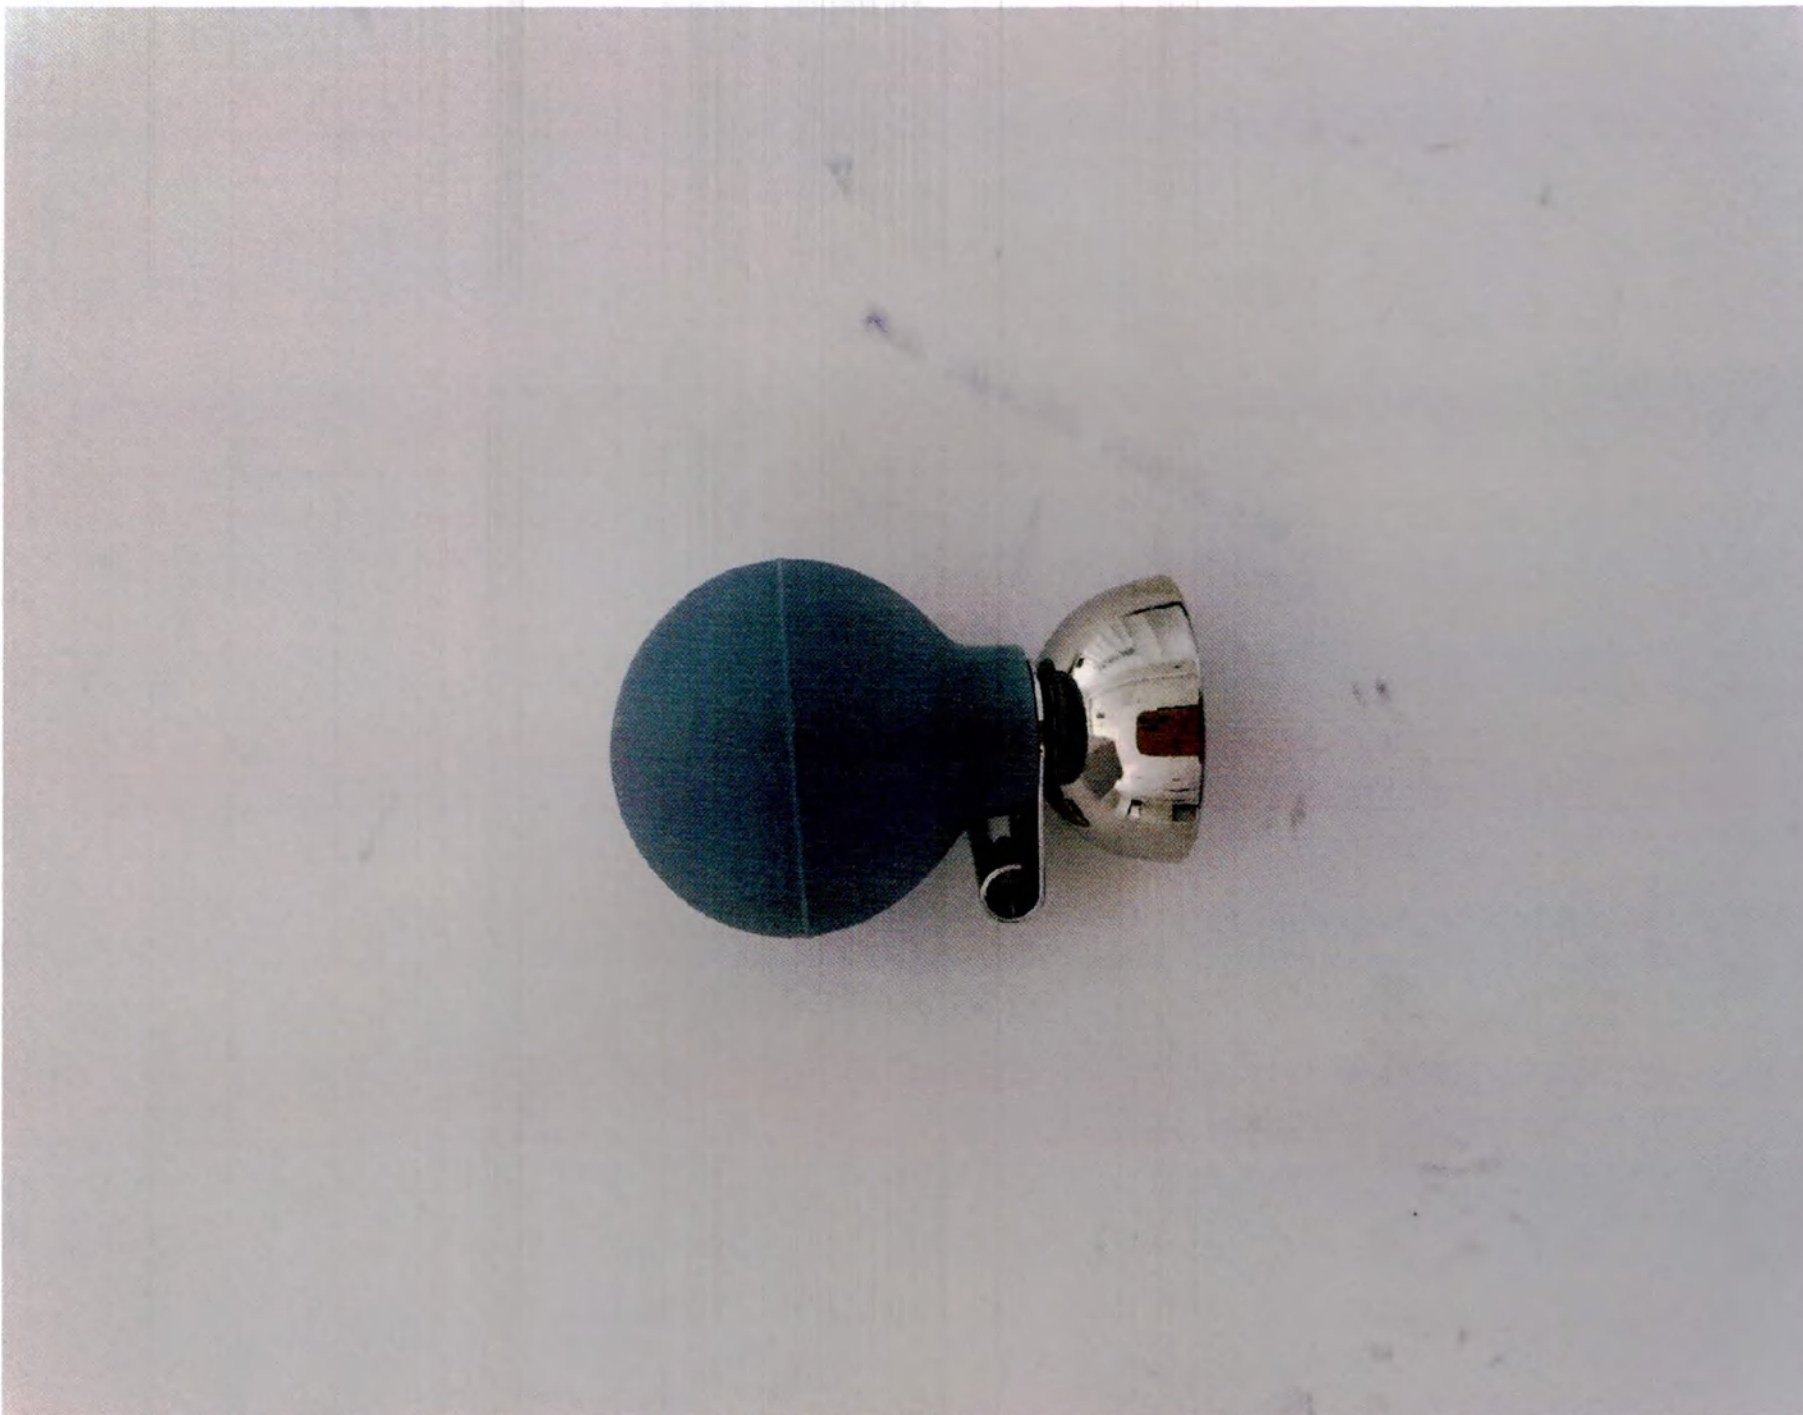

Электрод-груша для взрослых тип 1

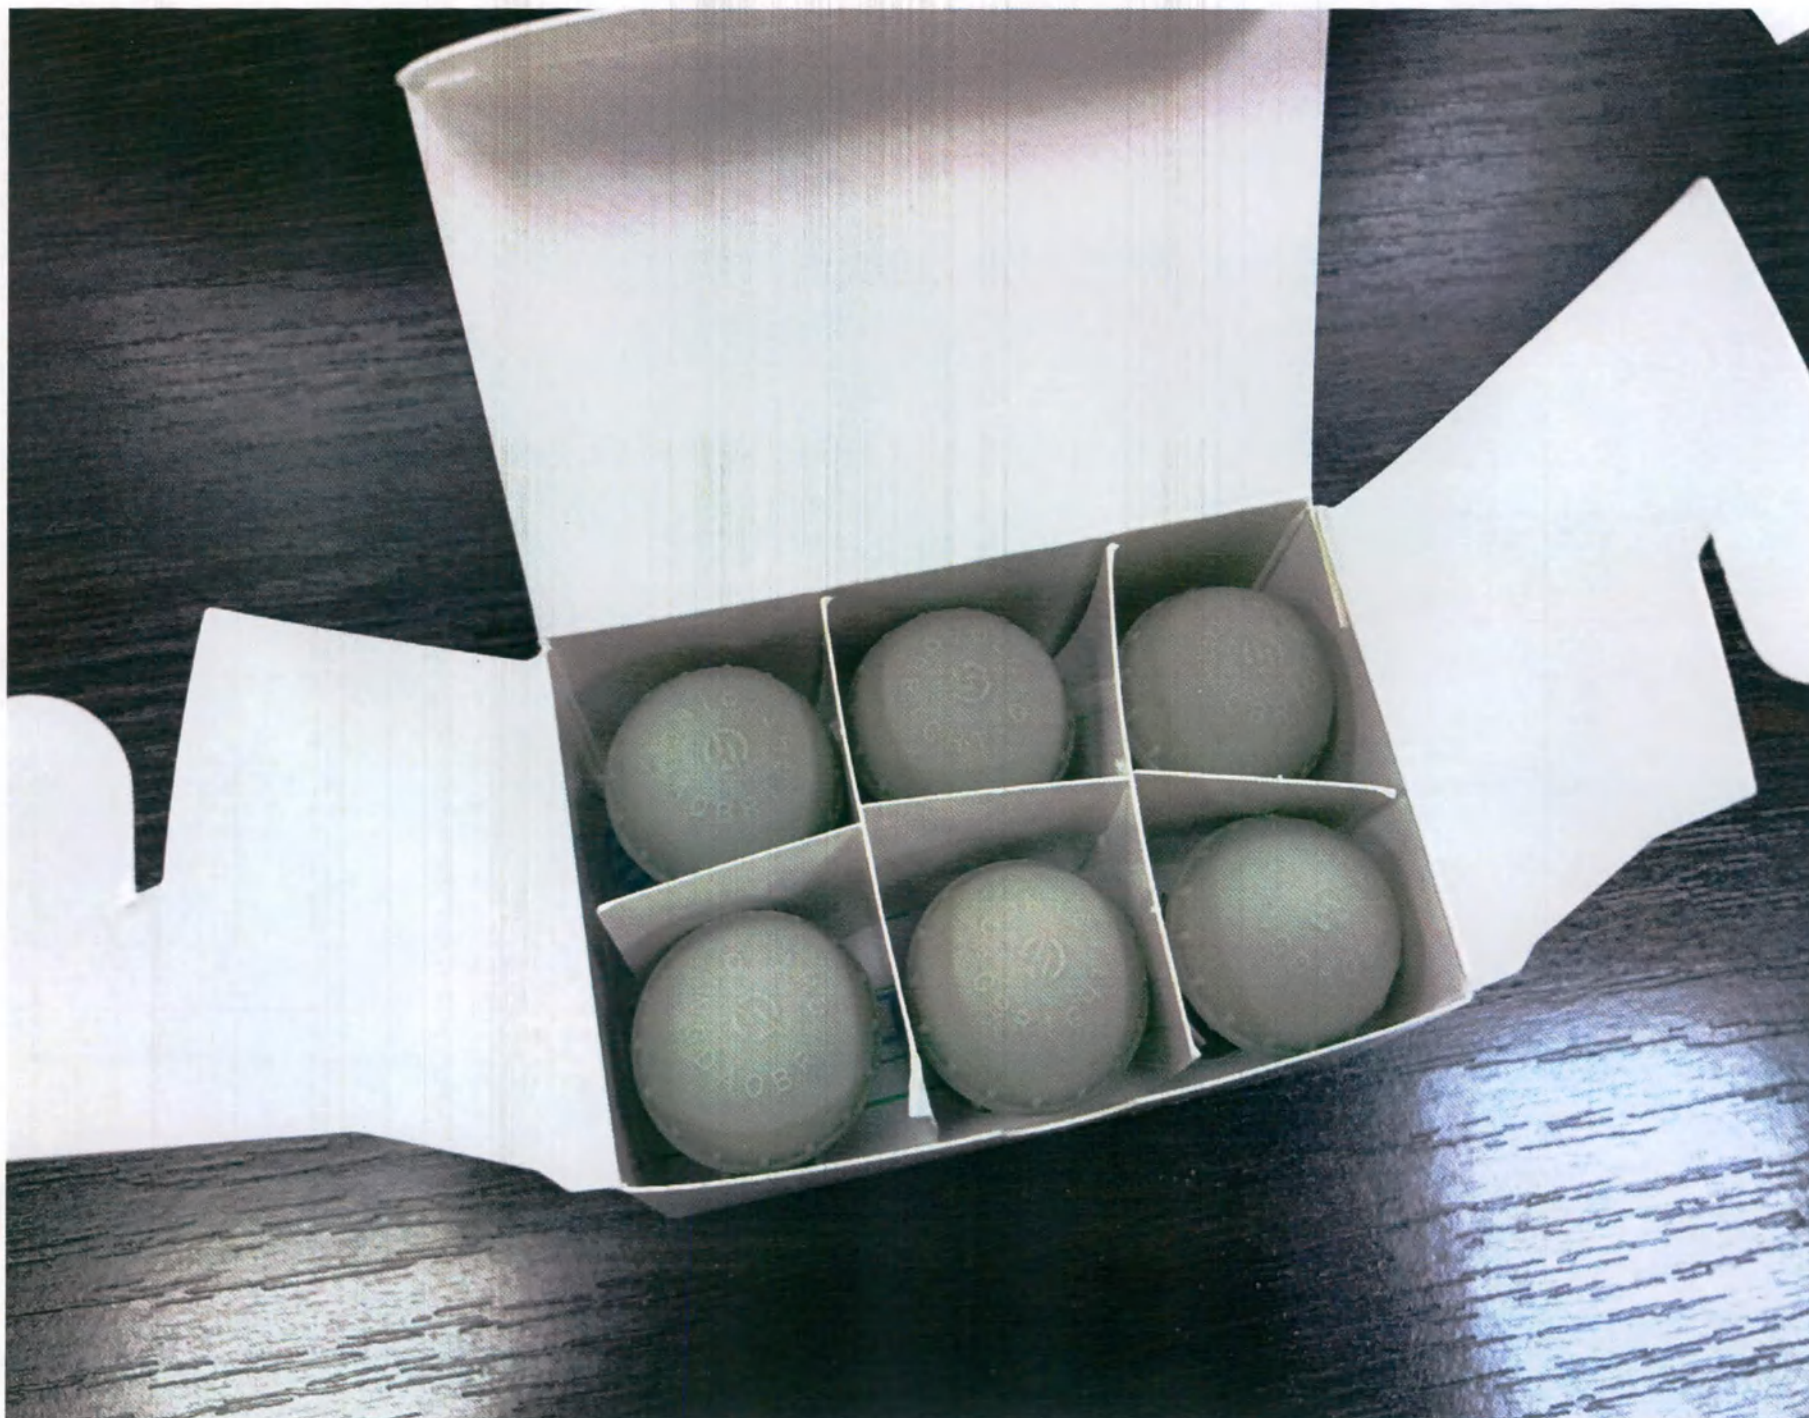

Электрод-груша для взрослых тип 2 (в упаковке)



Электрод-груша для взрослых тип 2 (общий вид)



Электрод-груша для взрослых тип 2

LOT

22110400017



30.10.2022

COMEN**Электрод-клипса для детей**

Количество в упаковке – 4 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China

Уполномоченный представитель на территории РФ:


ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, КИРИШСКАЯ УЛ., Д. 2,


ЛИТЕРА А, ОФИС ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 6Н С НОМ 39.49; +7-(812) 600-42-80.

Регистрационное удостоверение №

Электроды: макет маркировки упаковки

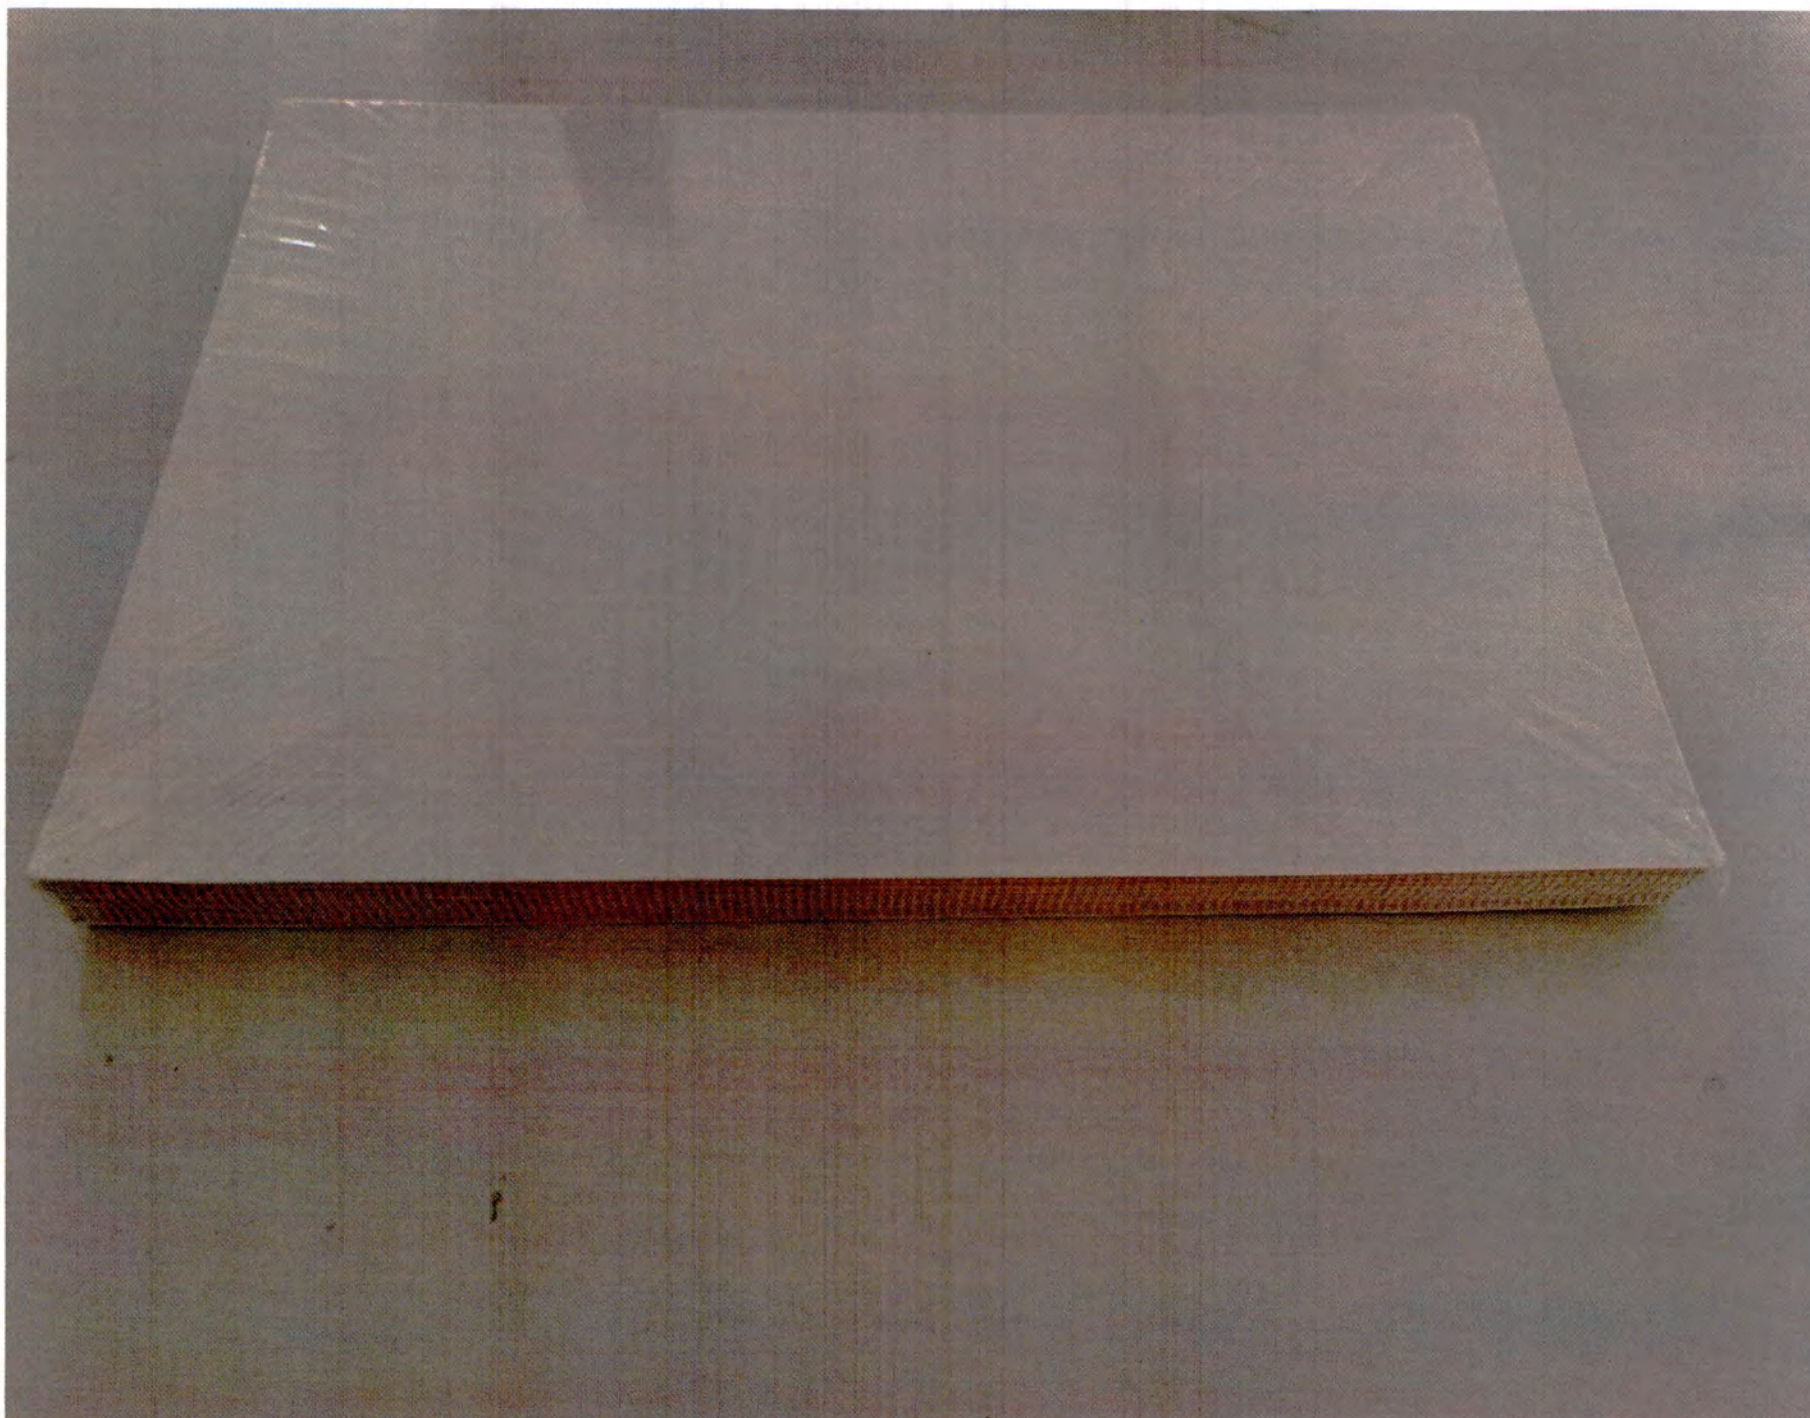

Бумага для печати для модели H12

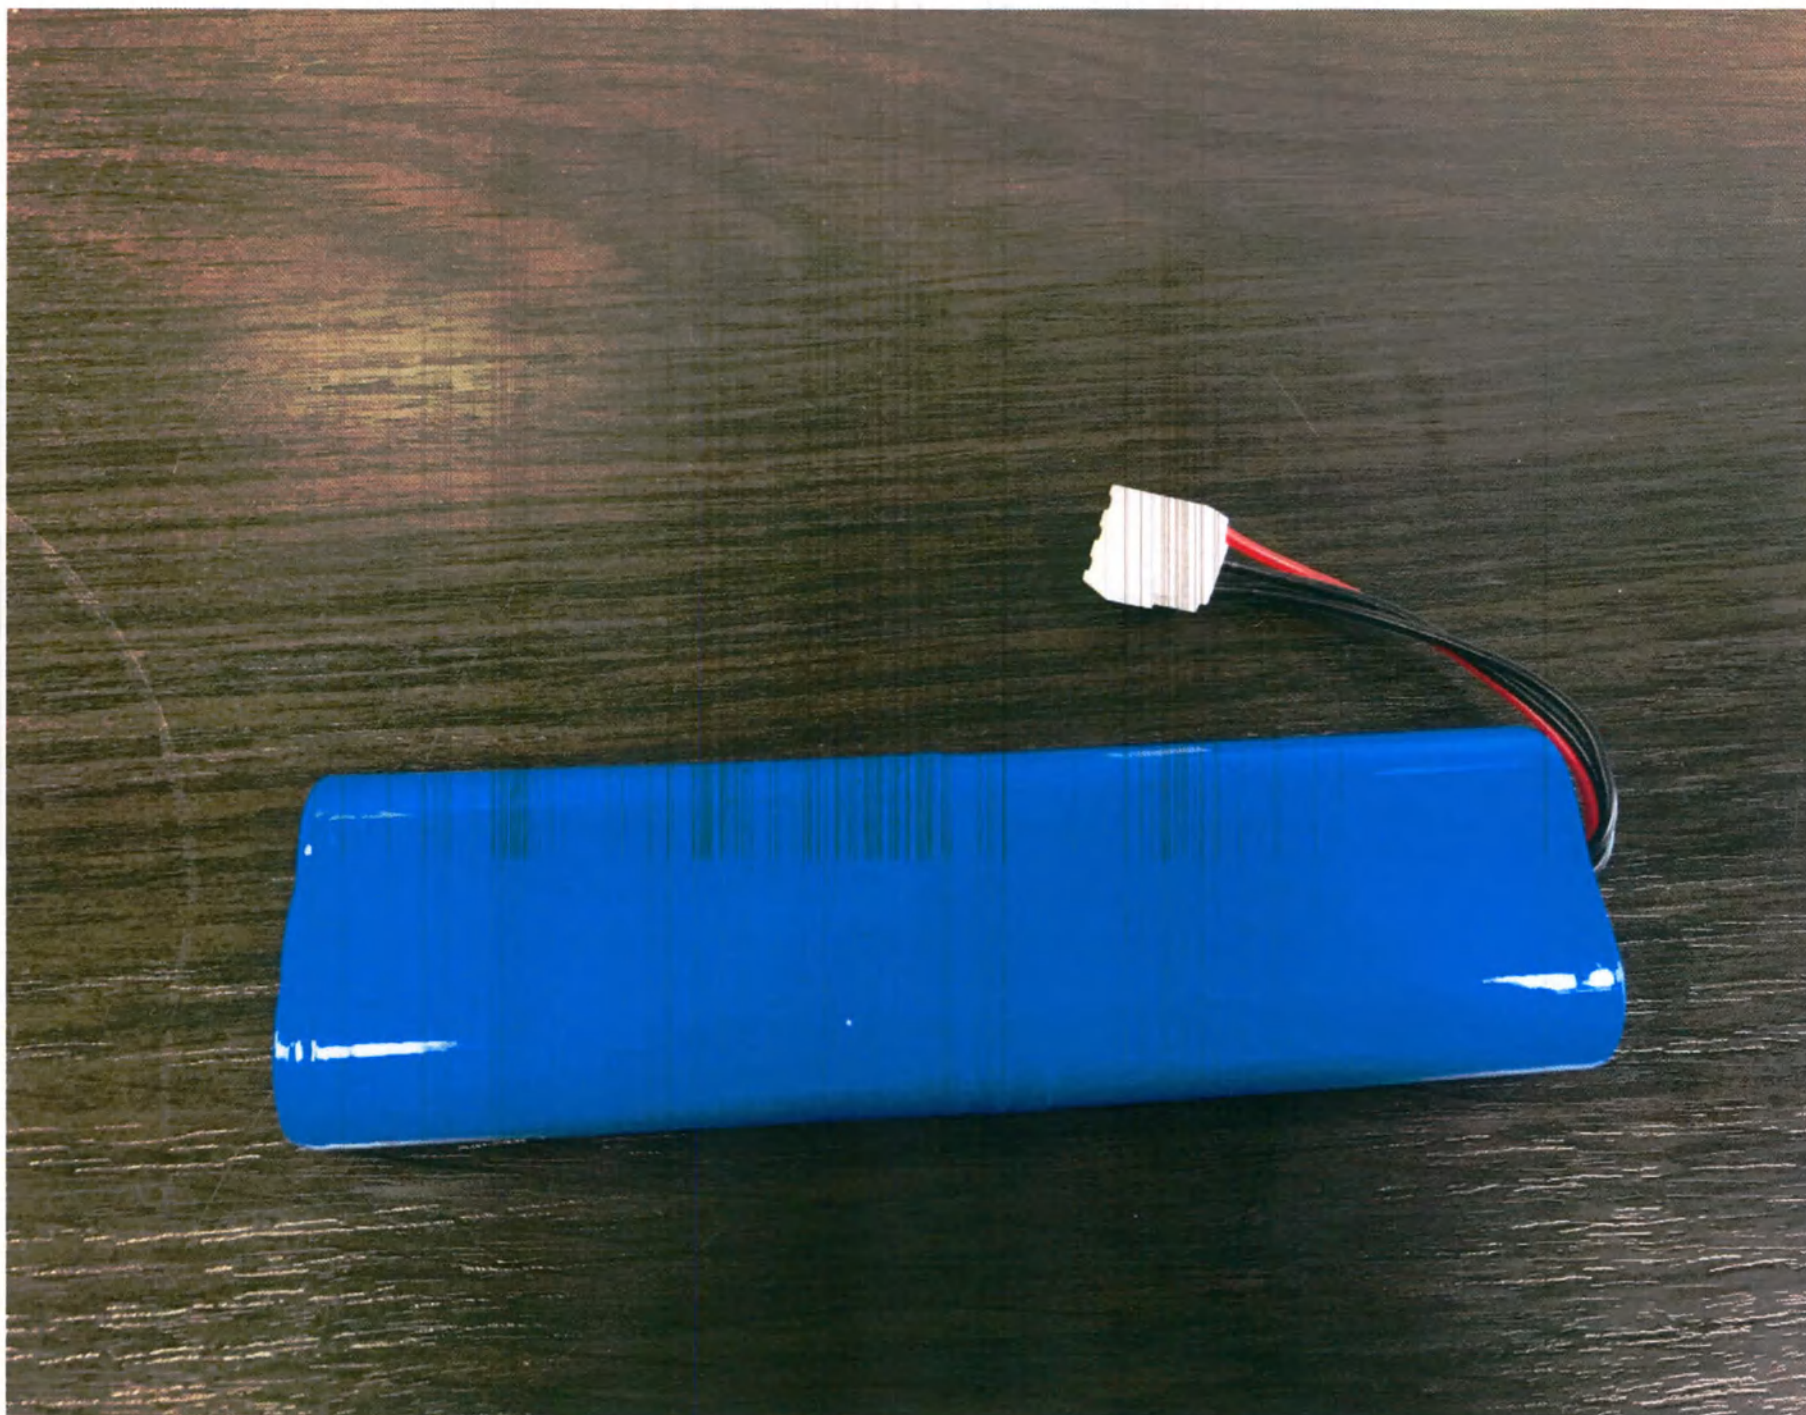

Батарея литиевая для модели H12



可充电锂离子电池
Rechargeable Li-ion Battery

深圳市松普美医疗设备有限公司
SHENZHEN CONSER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Model: 022-000138-00
DC11. 1V $\approx$ 2200mAh/24Wh



SHR162302202304210099

2023-04-21

MADE IN CHINA
中国制造




警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。
在 -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。推荐使用的
最高环境温度为 45°C (125°F)。

CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Don't crush, puncture, disassemble or short circuit the battery in -20°C (-4°F) to
 60°C (140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use. Maximum Recommended Ambient is
 45°C (125°F)

Батарея литиевая для модели H12 (маркировка)

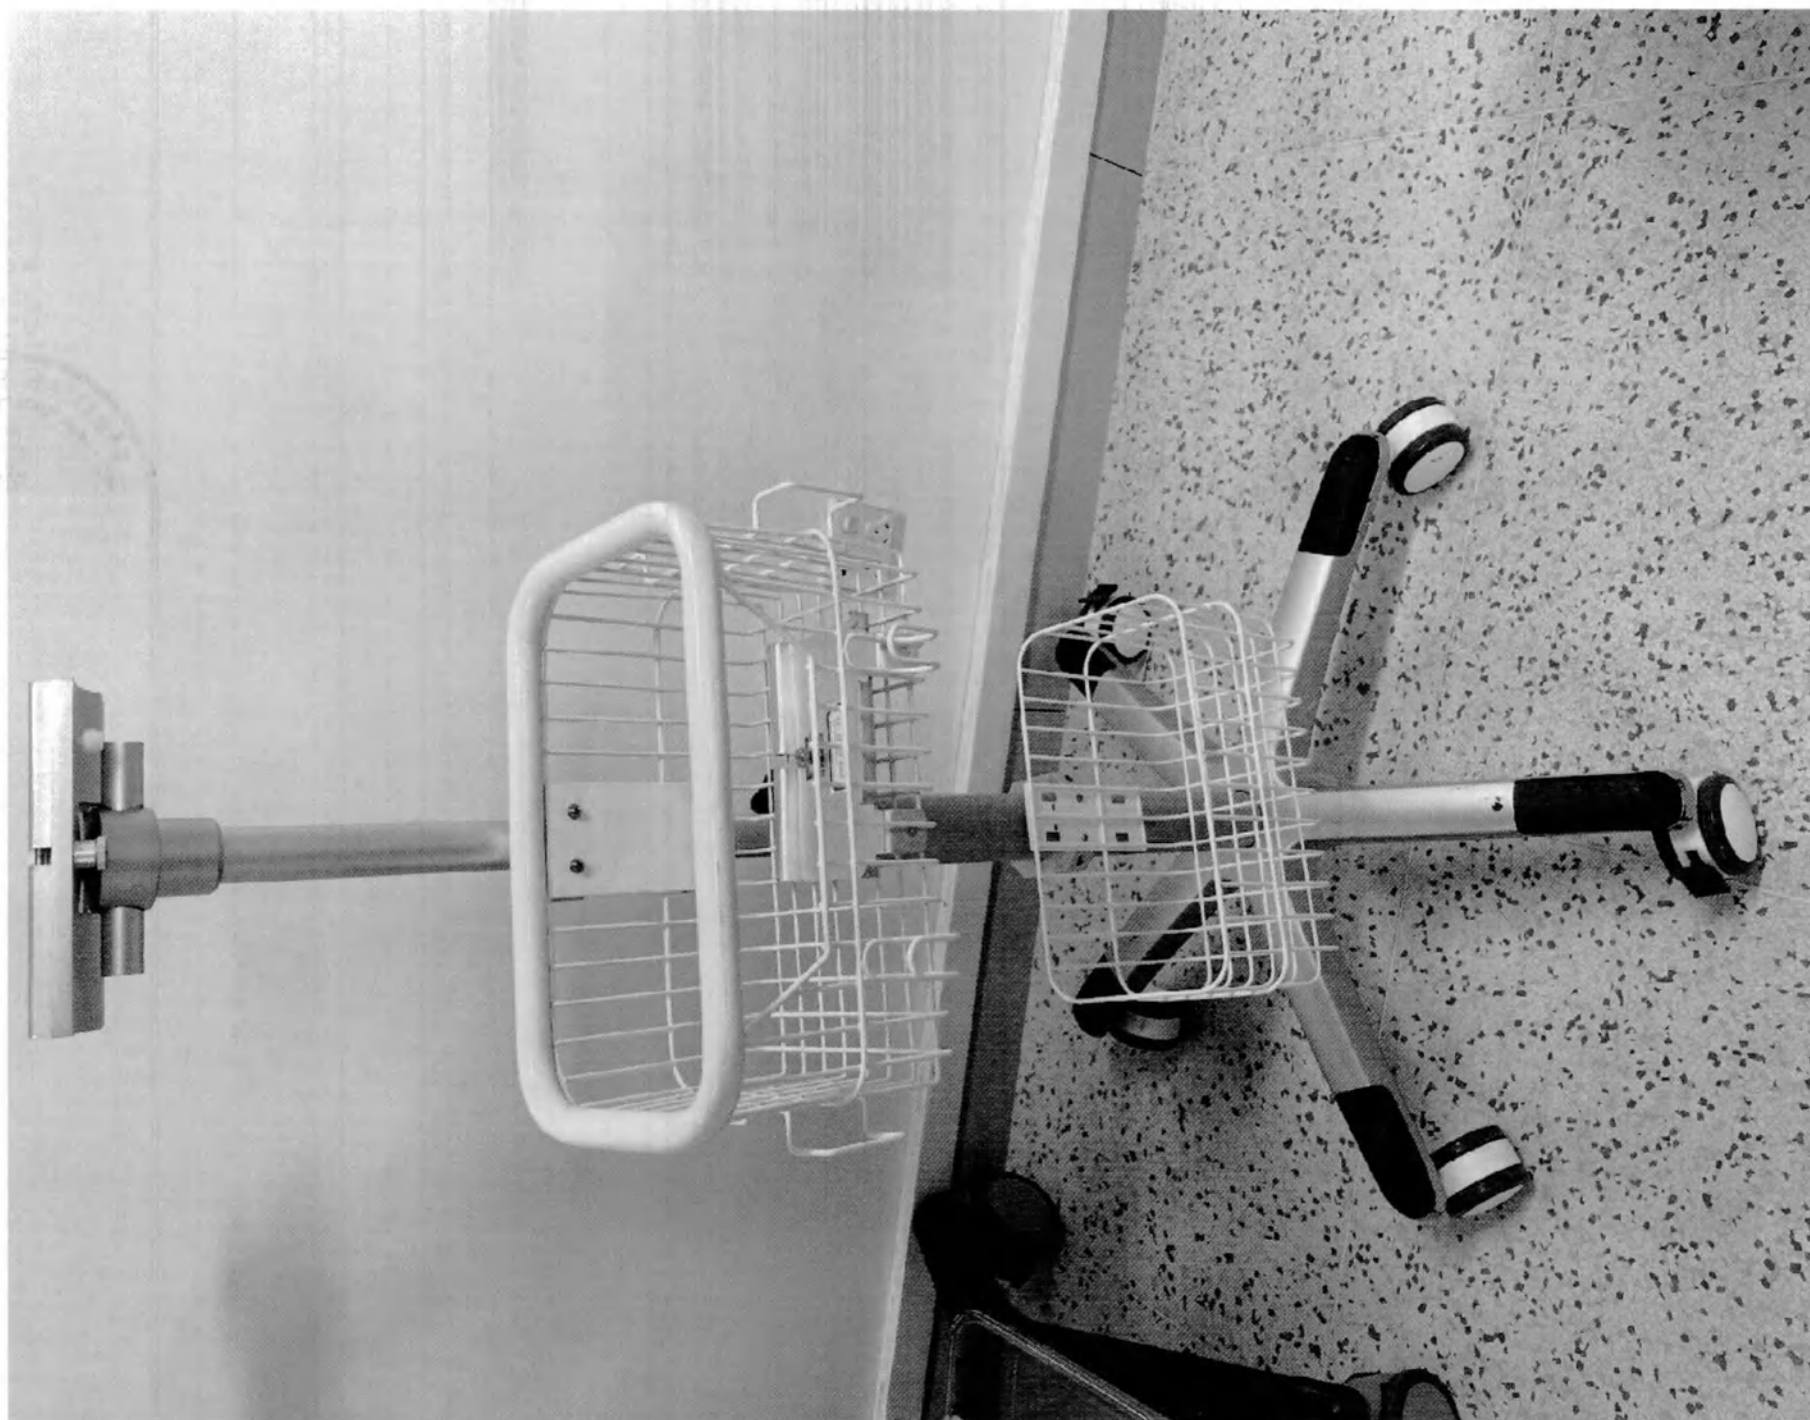

Тележка для модели H12

ВСЕГО
И СКРЕП

115 Л

