

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента Регистрации и Сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

А.П. Харитонов

«25» апреля 2024 г.



Фотографические изображения


«Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями»

Производства:

«GE Medical Systems (China) Co., Ltd., Китай (ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко, Лтд., Китай)


№19, Changjiang Road, Wuxi National Hi-Tech Development Zone, 214028 Jiangsu, China

I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями (пример Маркировки)


LOGIQ e		
REF	LOGIQ e	
SN	XXXXXXXXXX	
	XXXX-XX-XX	
	19-20B == 150B_T GE Medical Systems (China) Co., Ltd. №19, Changjiang Road, Wuxi National Hi-Tech Development Zone, 214028 Jiangsu, China	
UDI		
(01)0 XXXXXXX XXXXX X (11)XXXXXX (21) XXXXXXXXXXXX		

I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями


1. Консоль ультразвуковая.

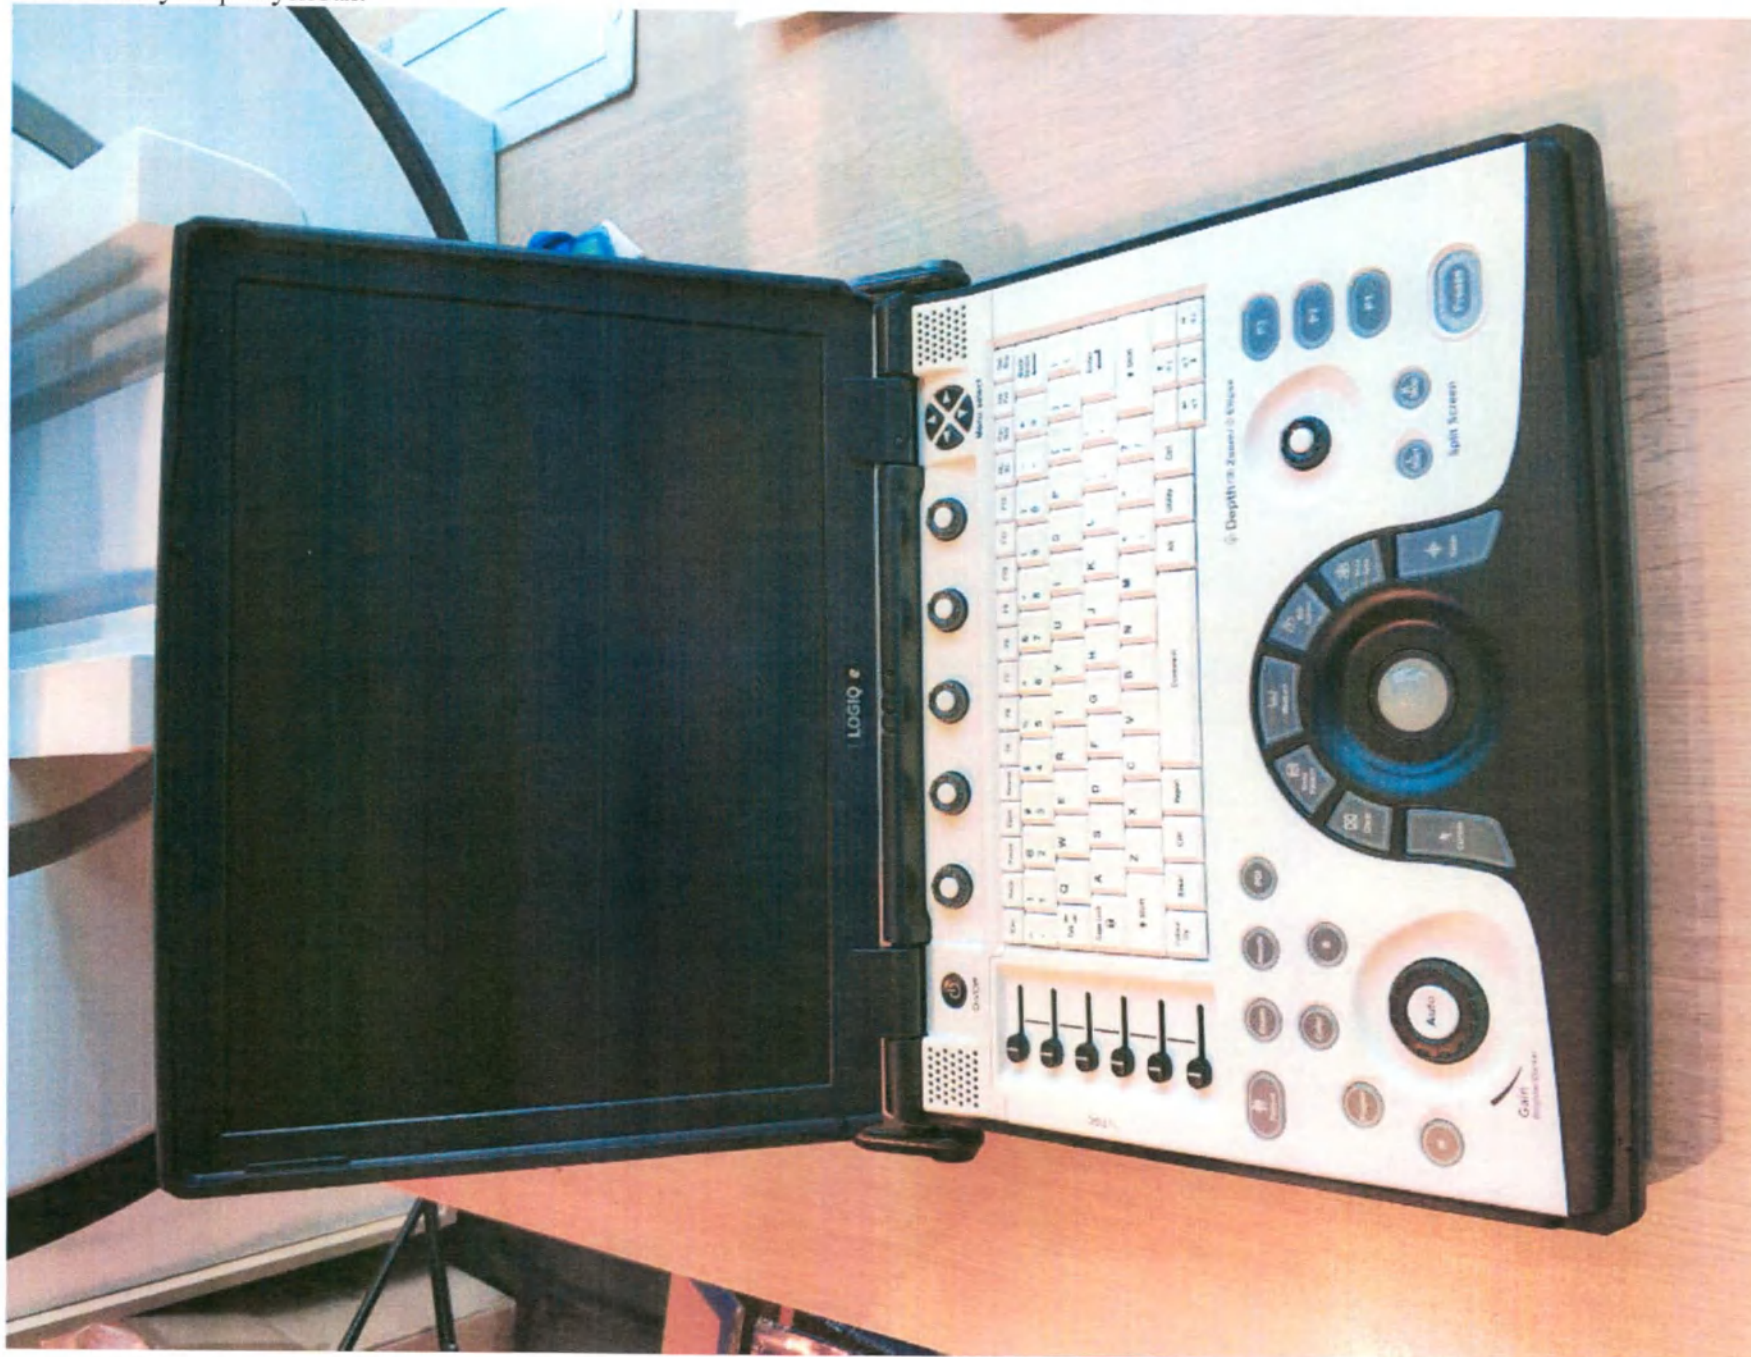


2. Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской.

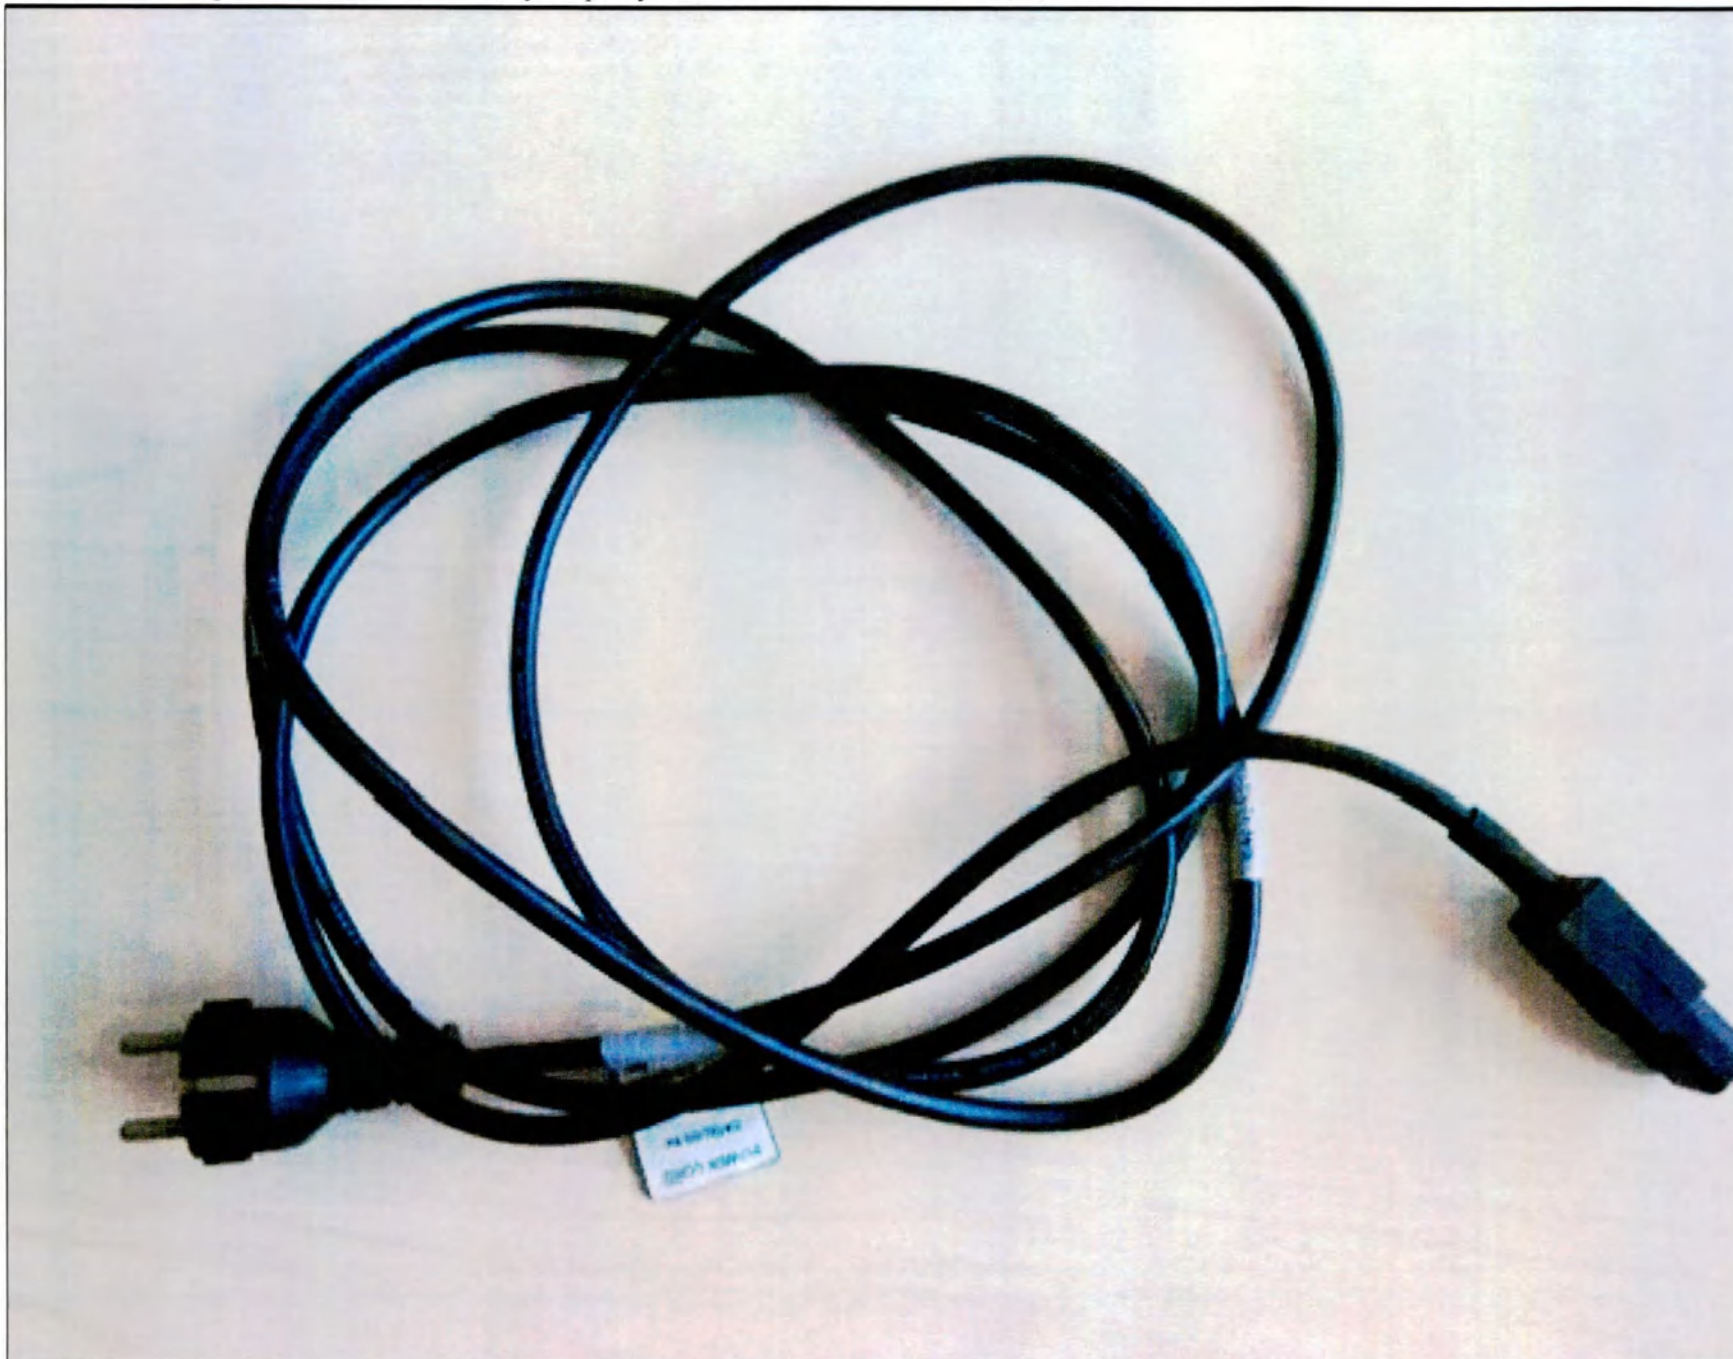

3. Руководство пользователя

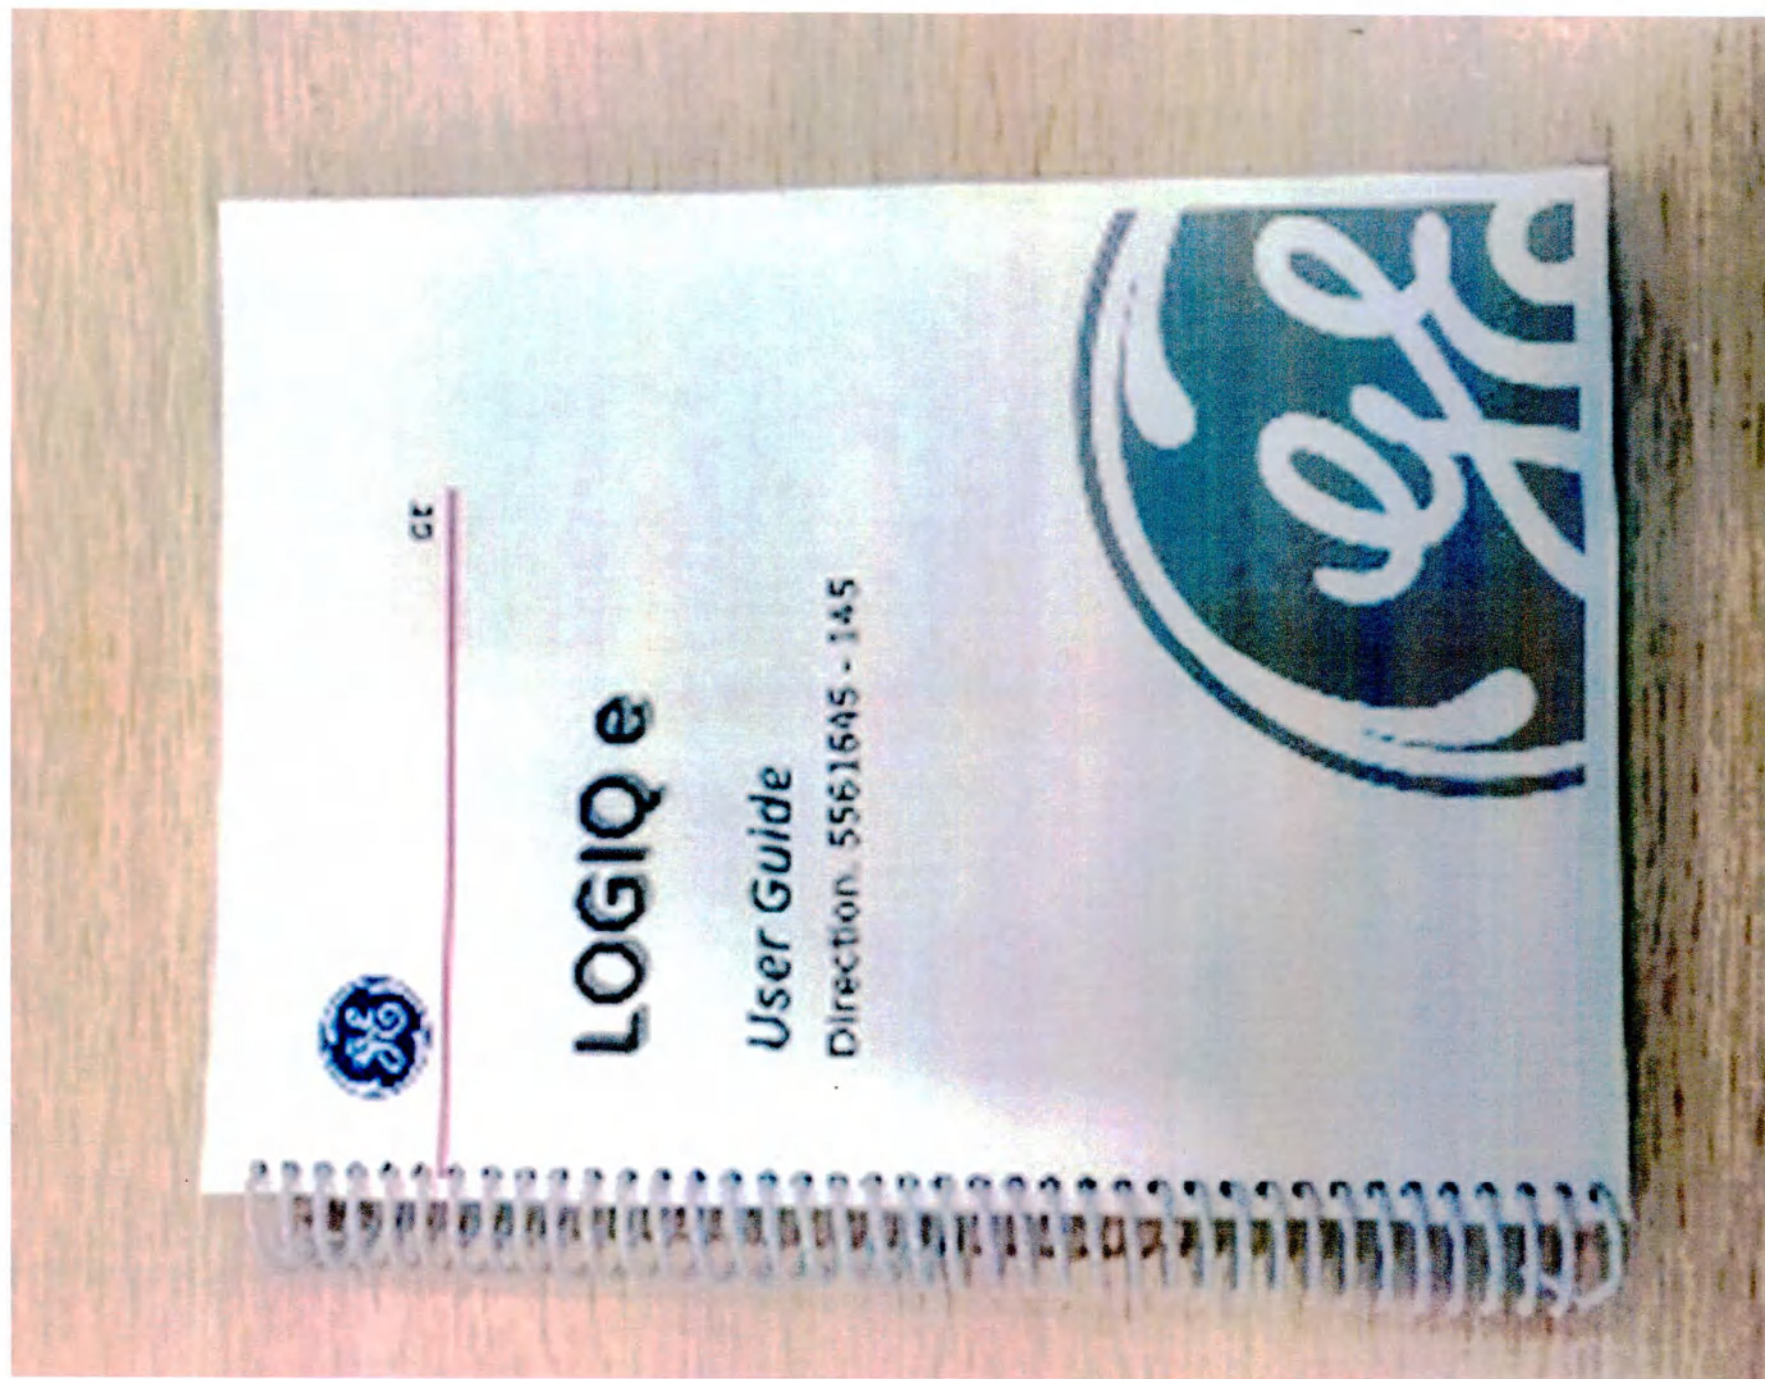


4. Датчик конвексный C1-5-RS

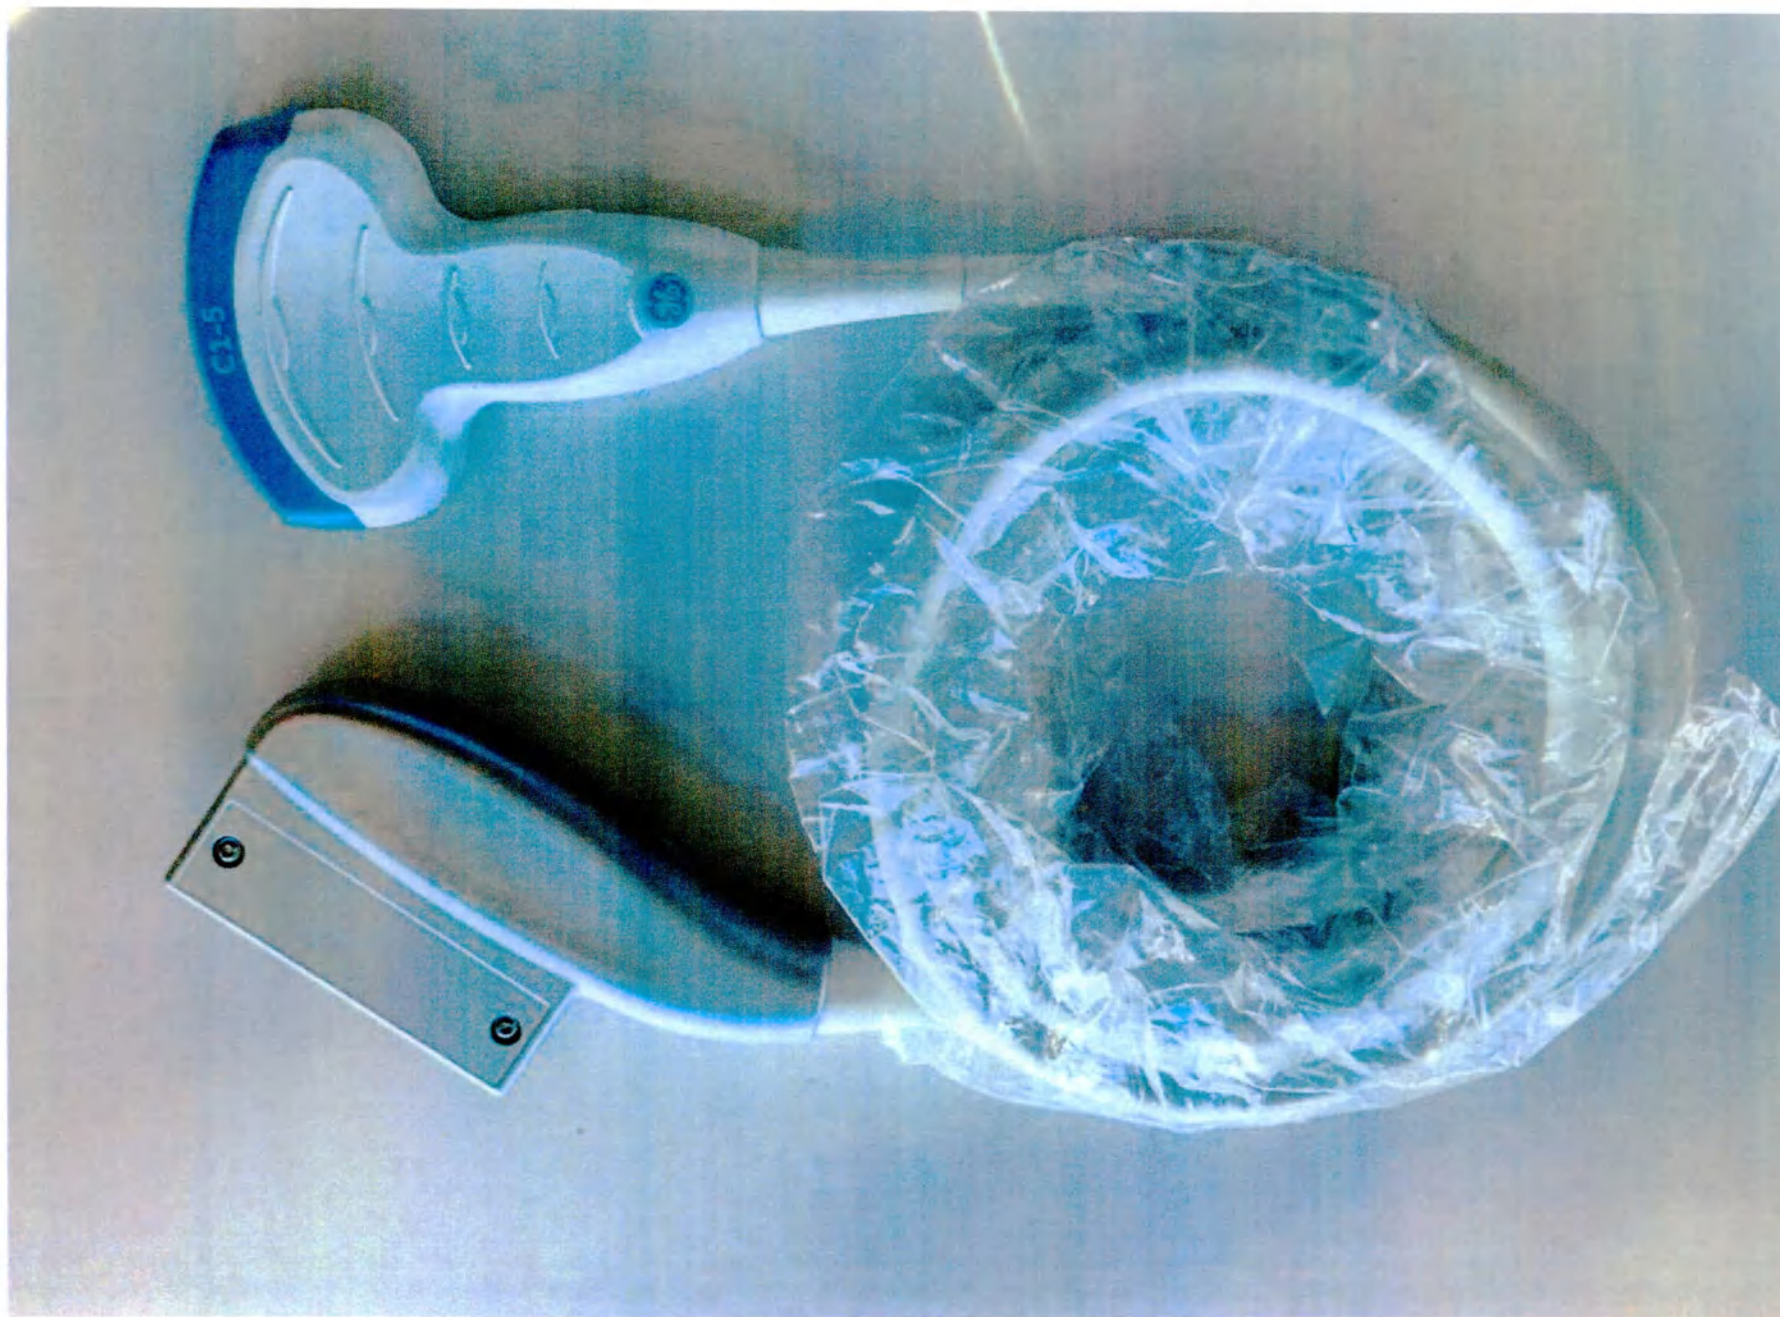


5. Датчик микроконвексный 8C-RS




6. Датчик микроконвексный внутриполостной E8C-RS

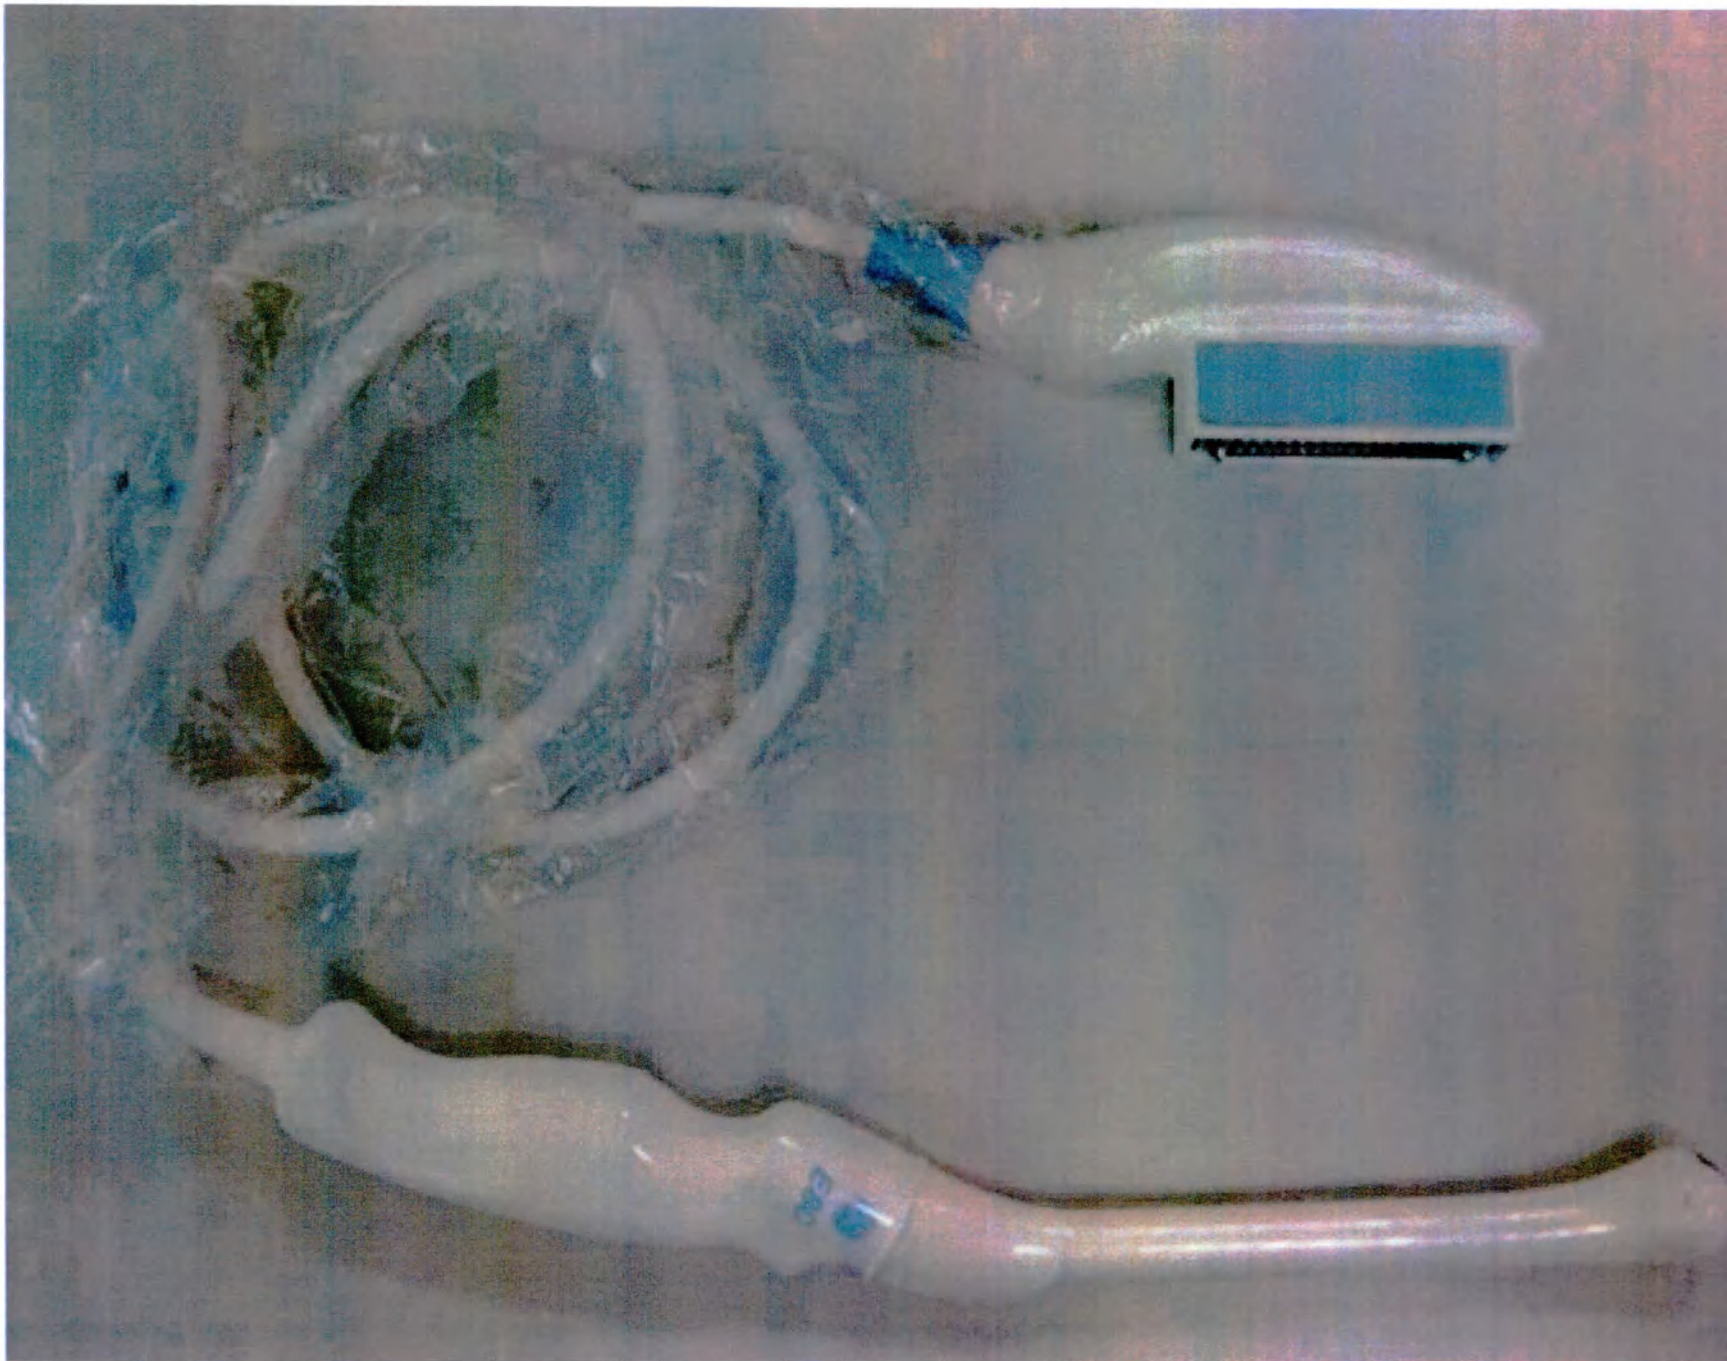

7. Датчики линейные серии L: 7.1 Датчик линейный 9L-RS

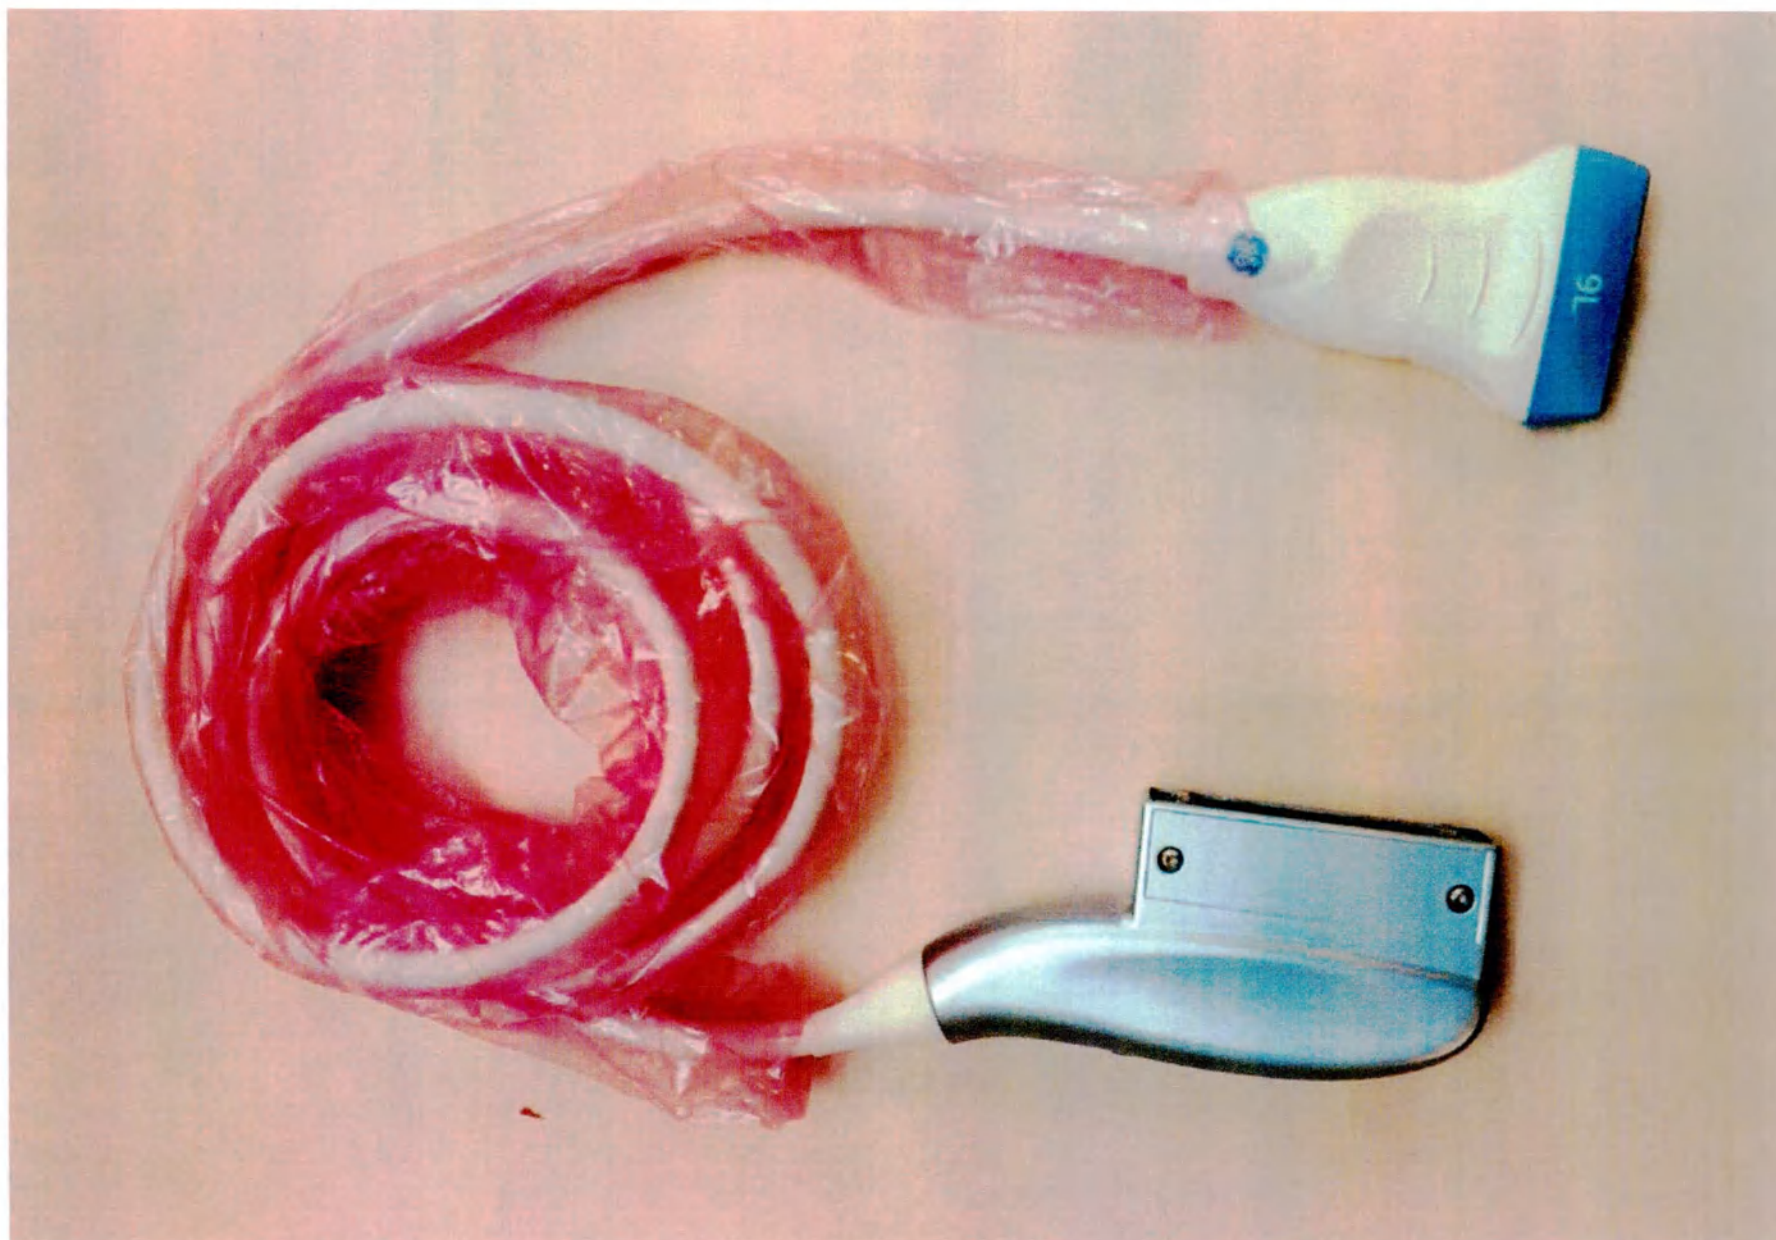

7. Датчики линейные серии L: 7.2 Датчик линейный 12L-RS

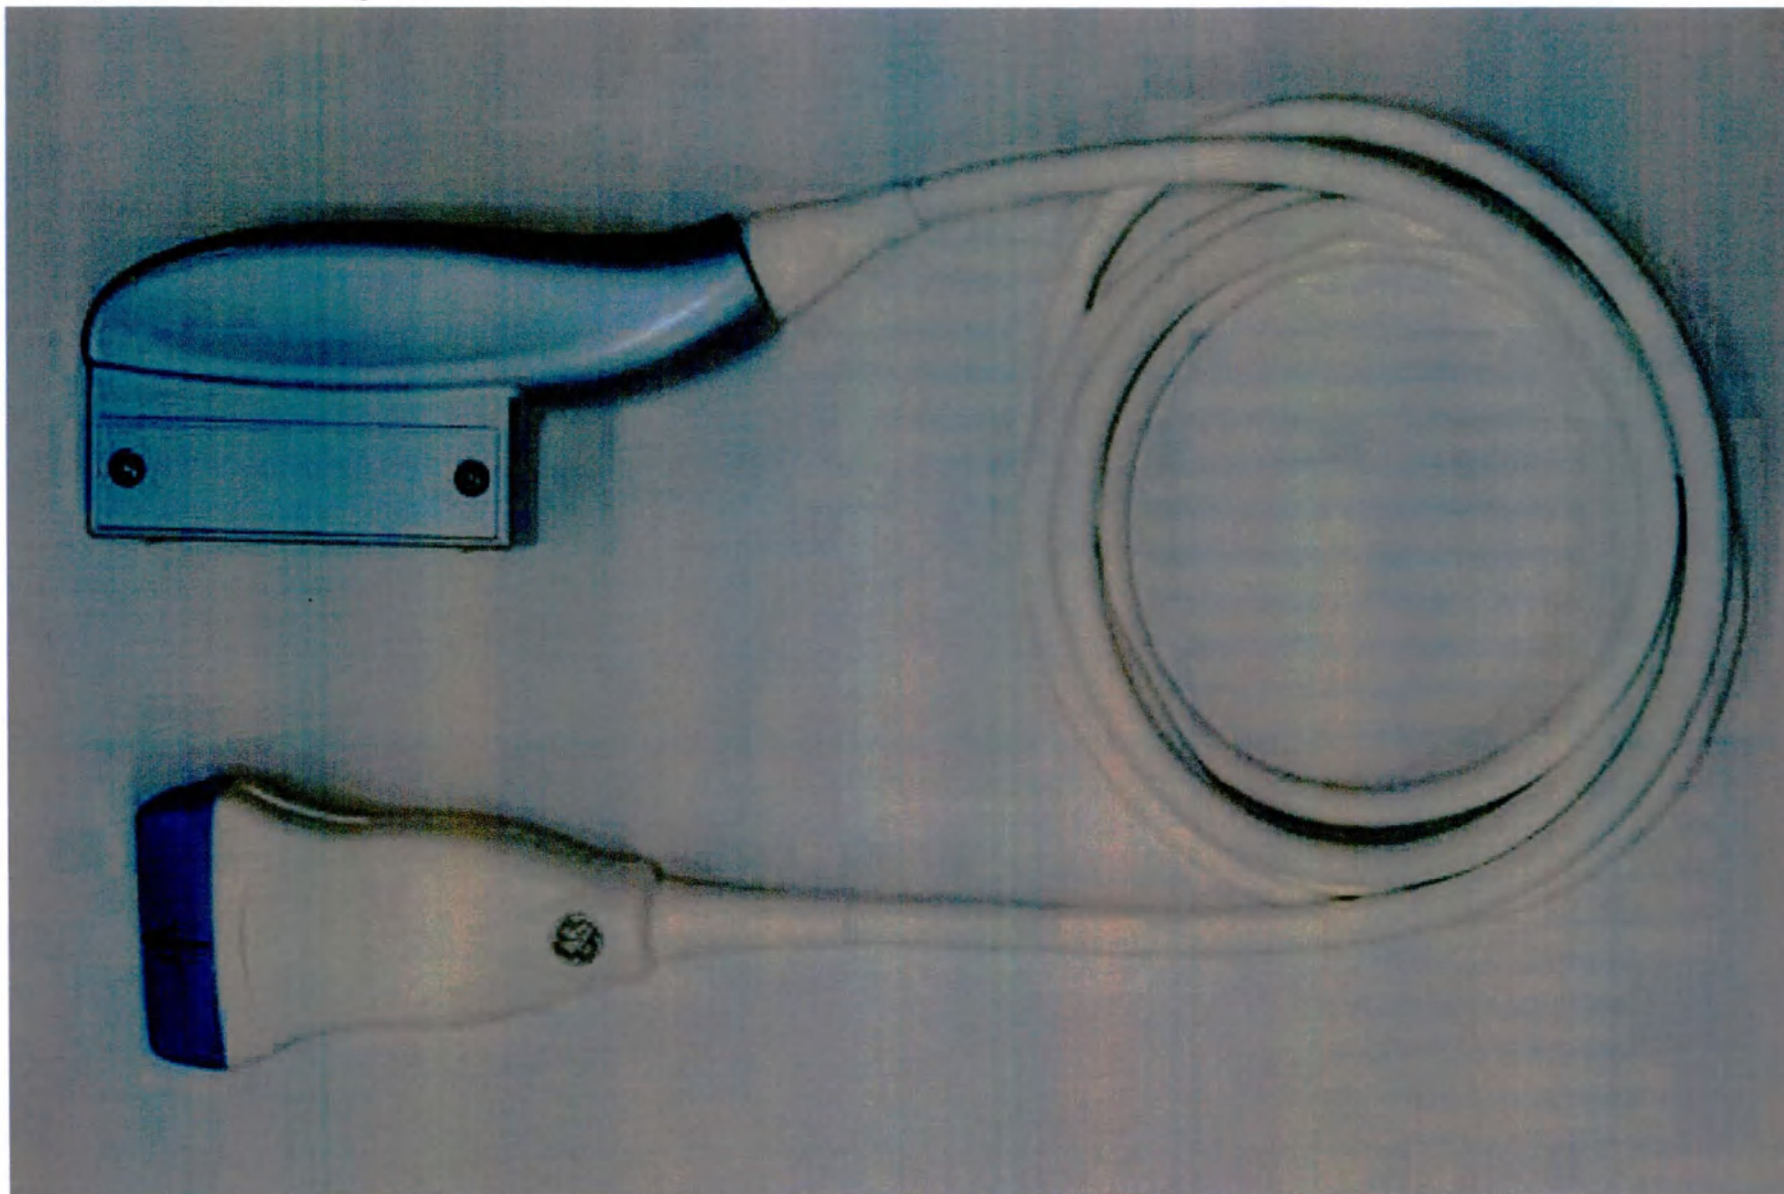


7. Датчики линейные серии L: 7.3 Датчик линейный широкополосный L10-22-RS



8. Датчик линейный L8-18i-RS




9. Датчик линейный L4-12t-RS

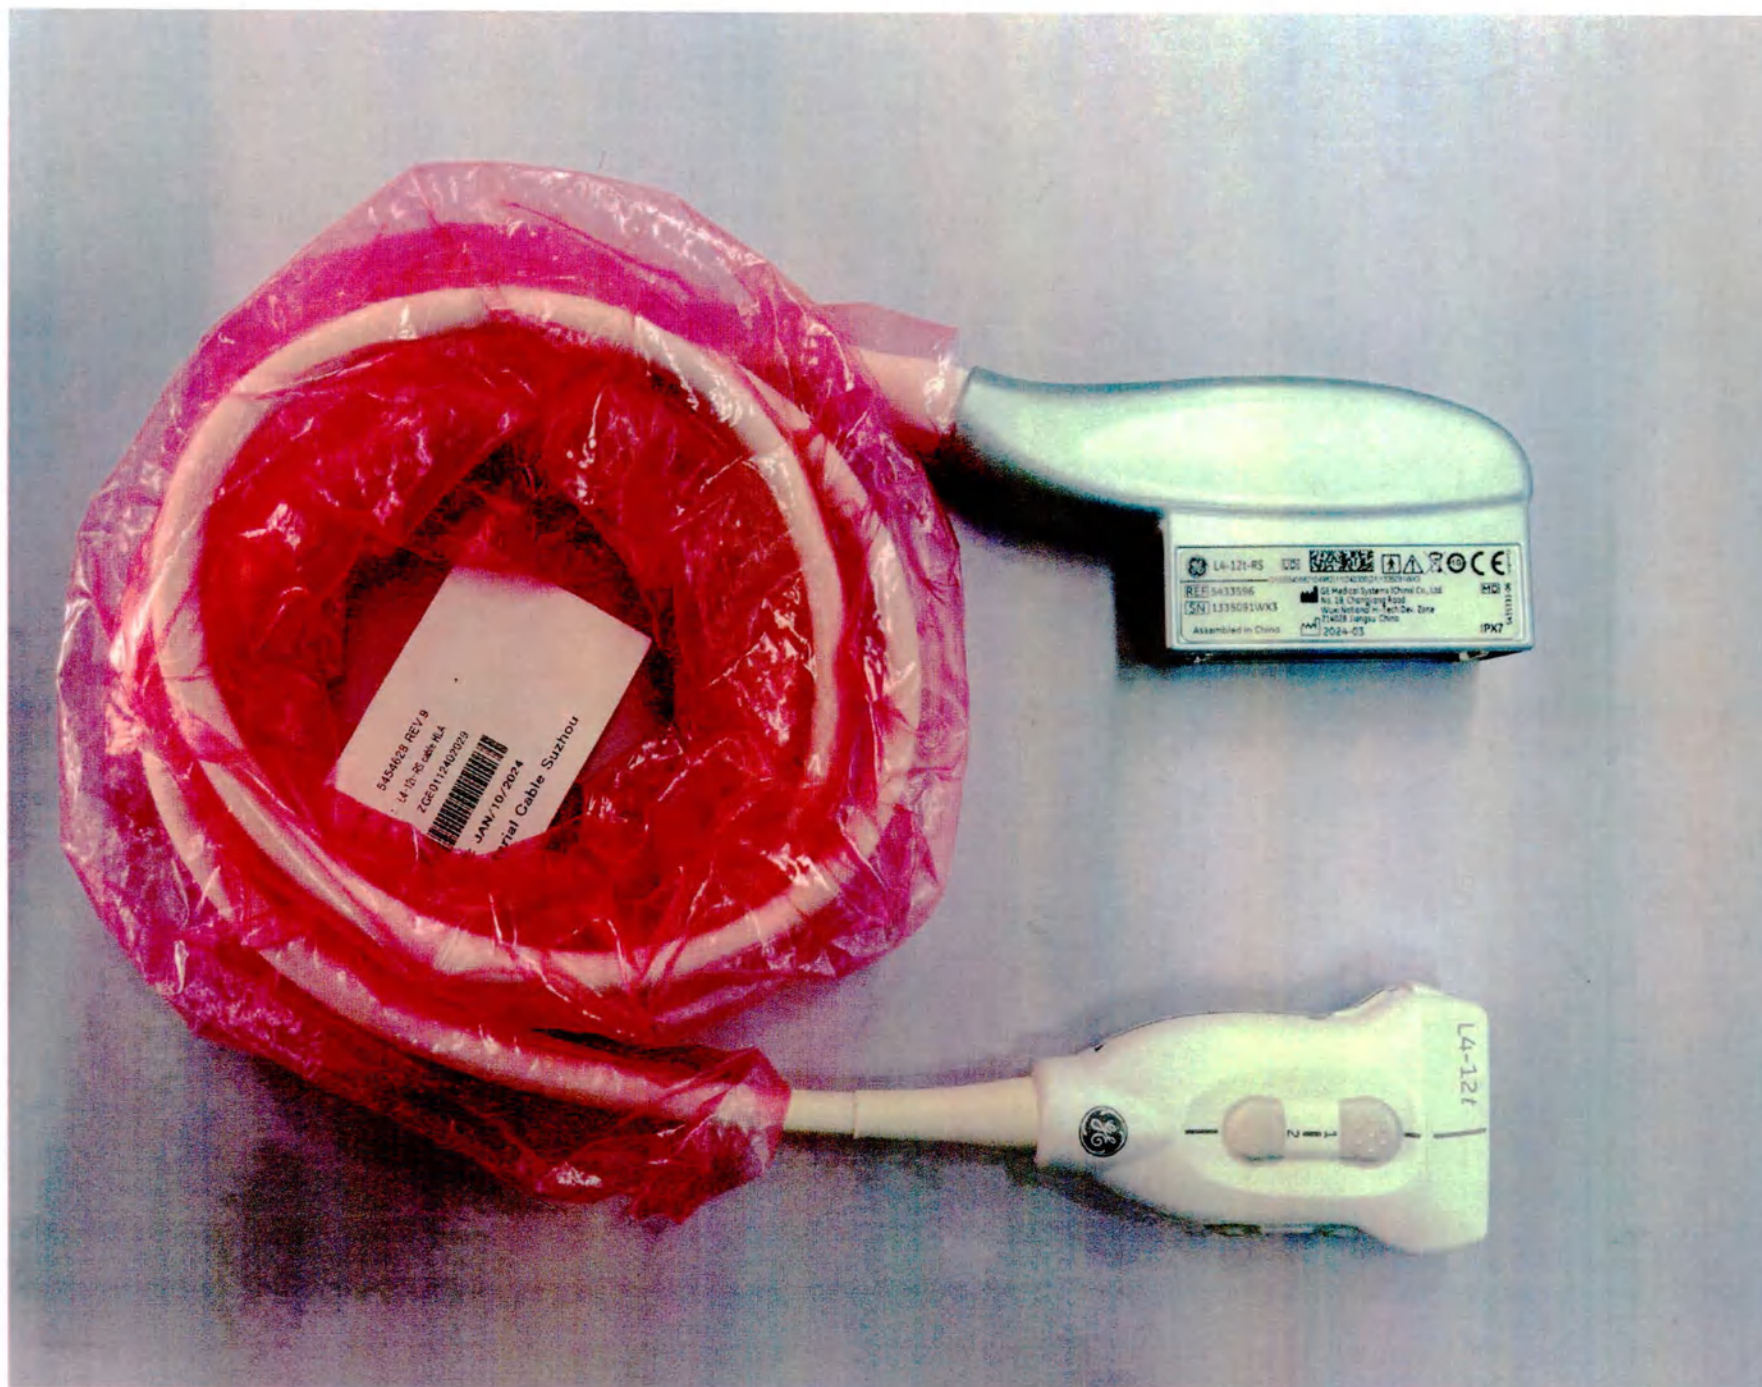


10. Датчик линейный матричный ML6-15-RS



11. Датчики секторные фазированные серии S: 11.1 Датчик секторный фазированный широкополосный 3Sc-RS

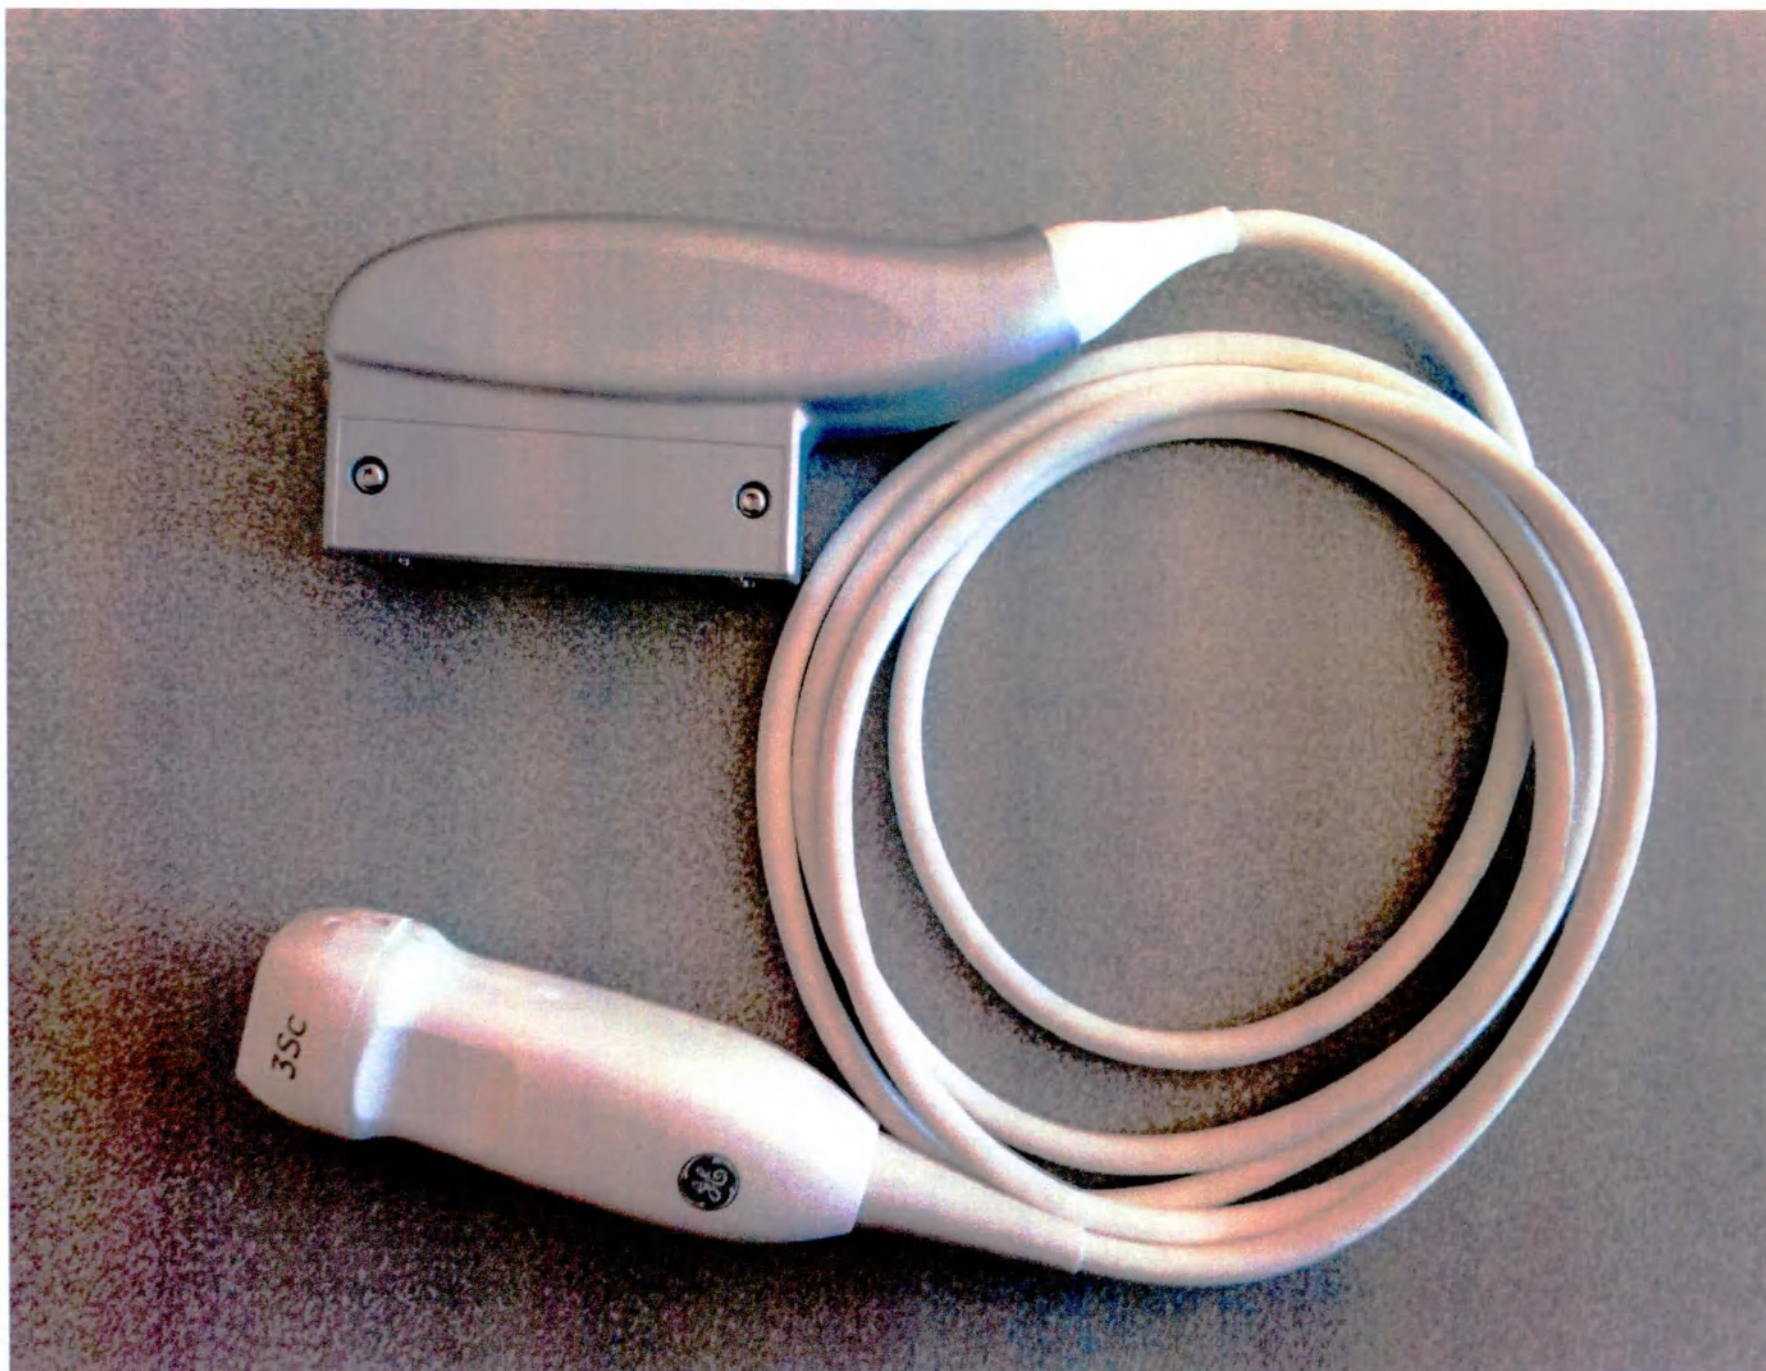

11. Датчики секторные фазированные серии S: 11.2 Датчик секторный фазированный широкополосный 6S-RS

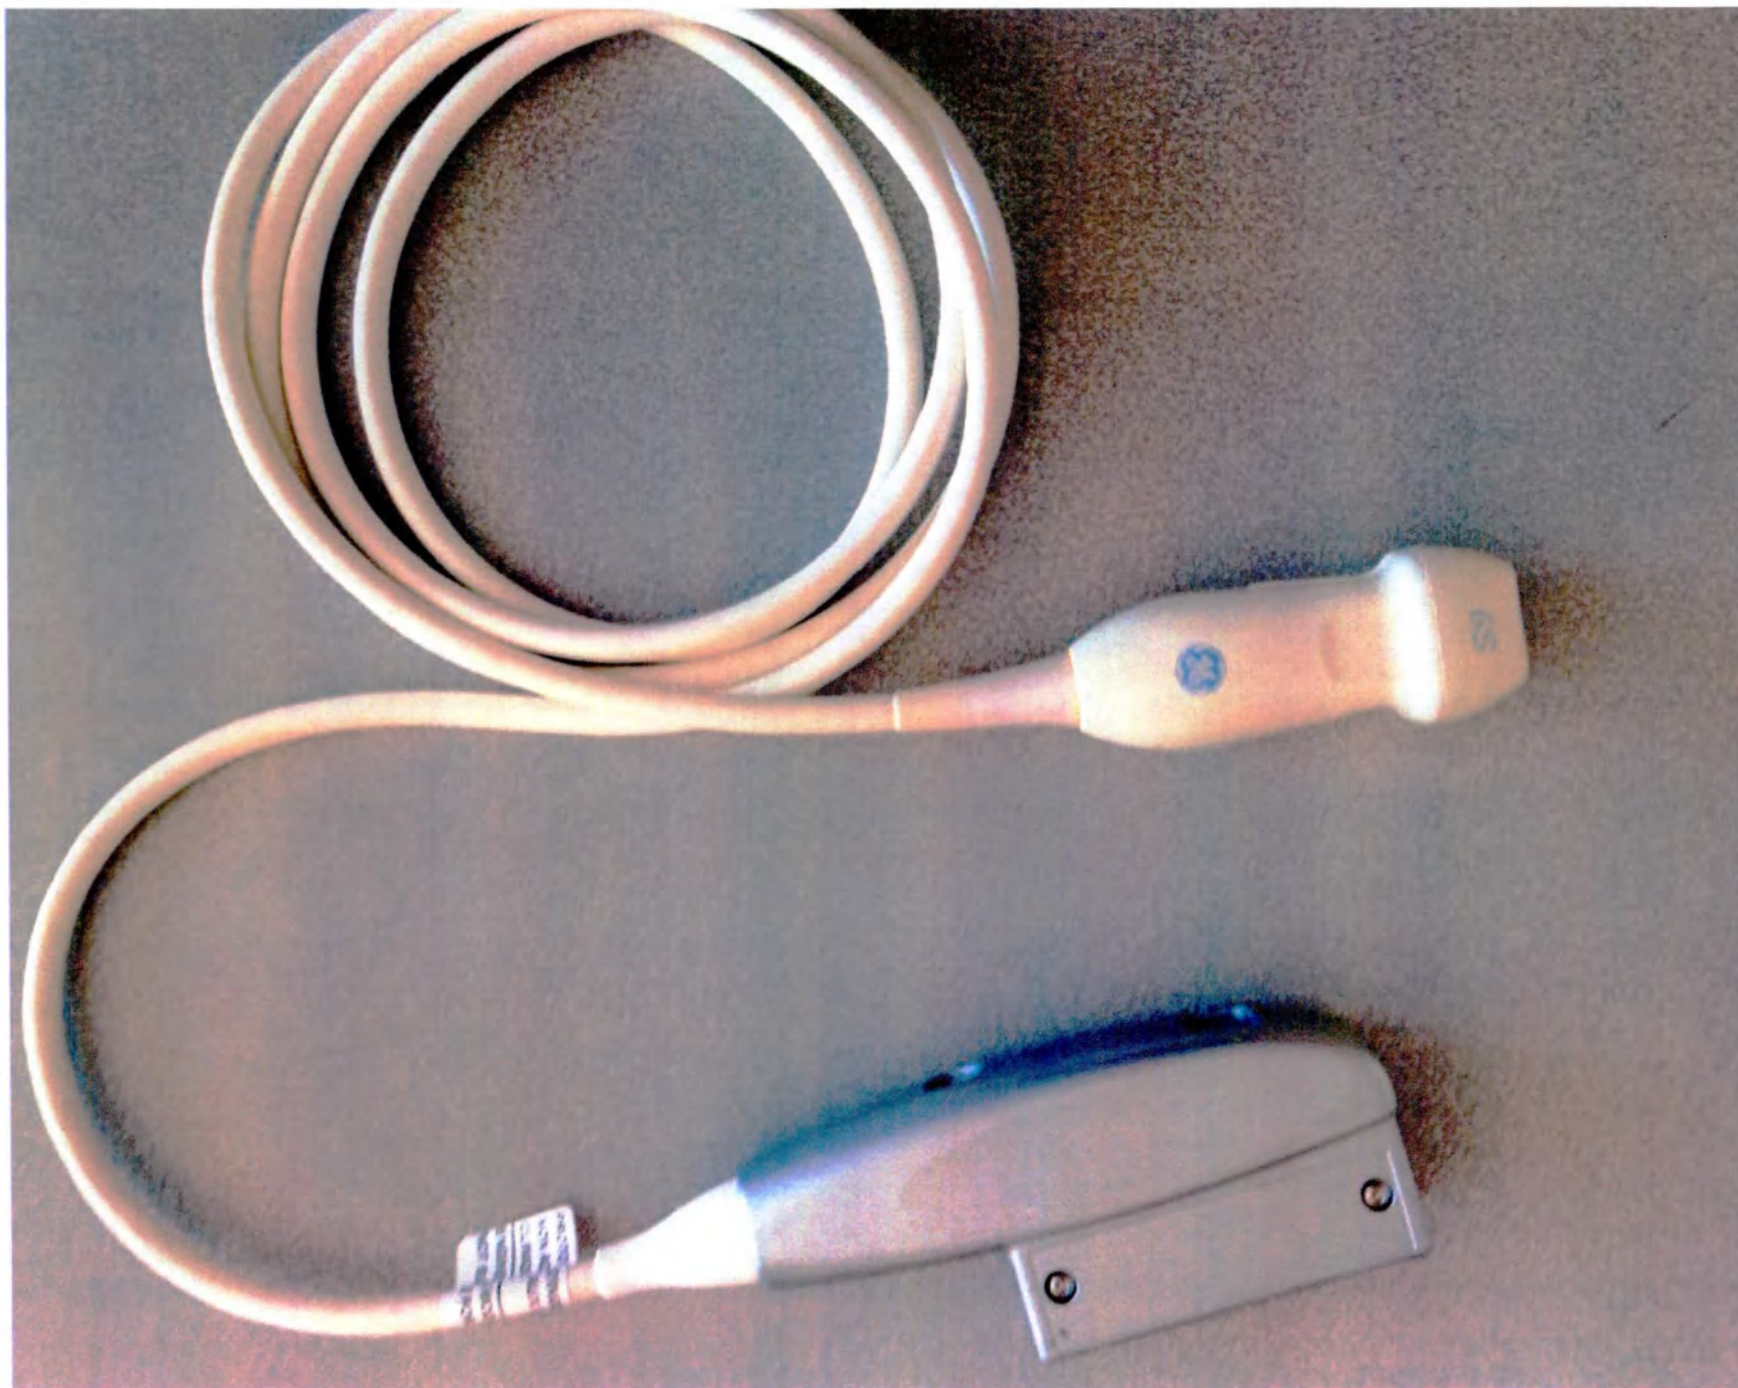


12. Датчик чреспищеводный фазированный 6Тс-RS



Принадлежности: 1. Программное обеспечение для ультразвуковых исследований High-Res PDI Option, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



2. Программное обеспечение для ультразвуковых исследований Ophthalmic Option, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

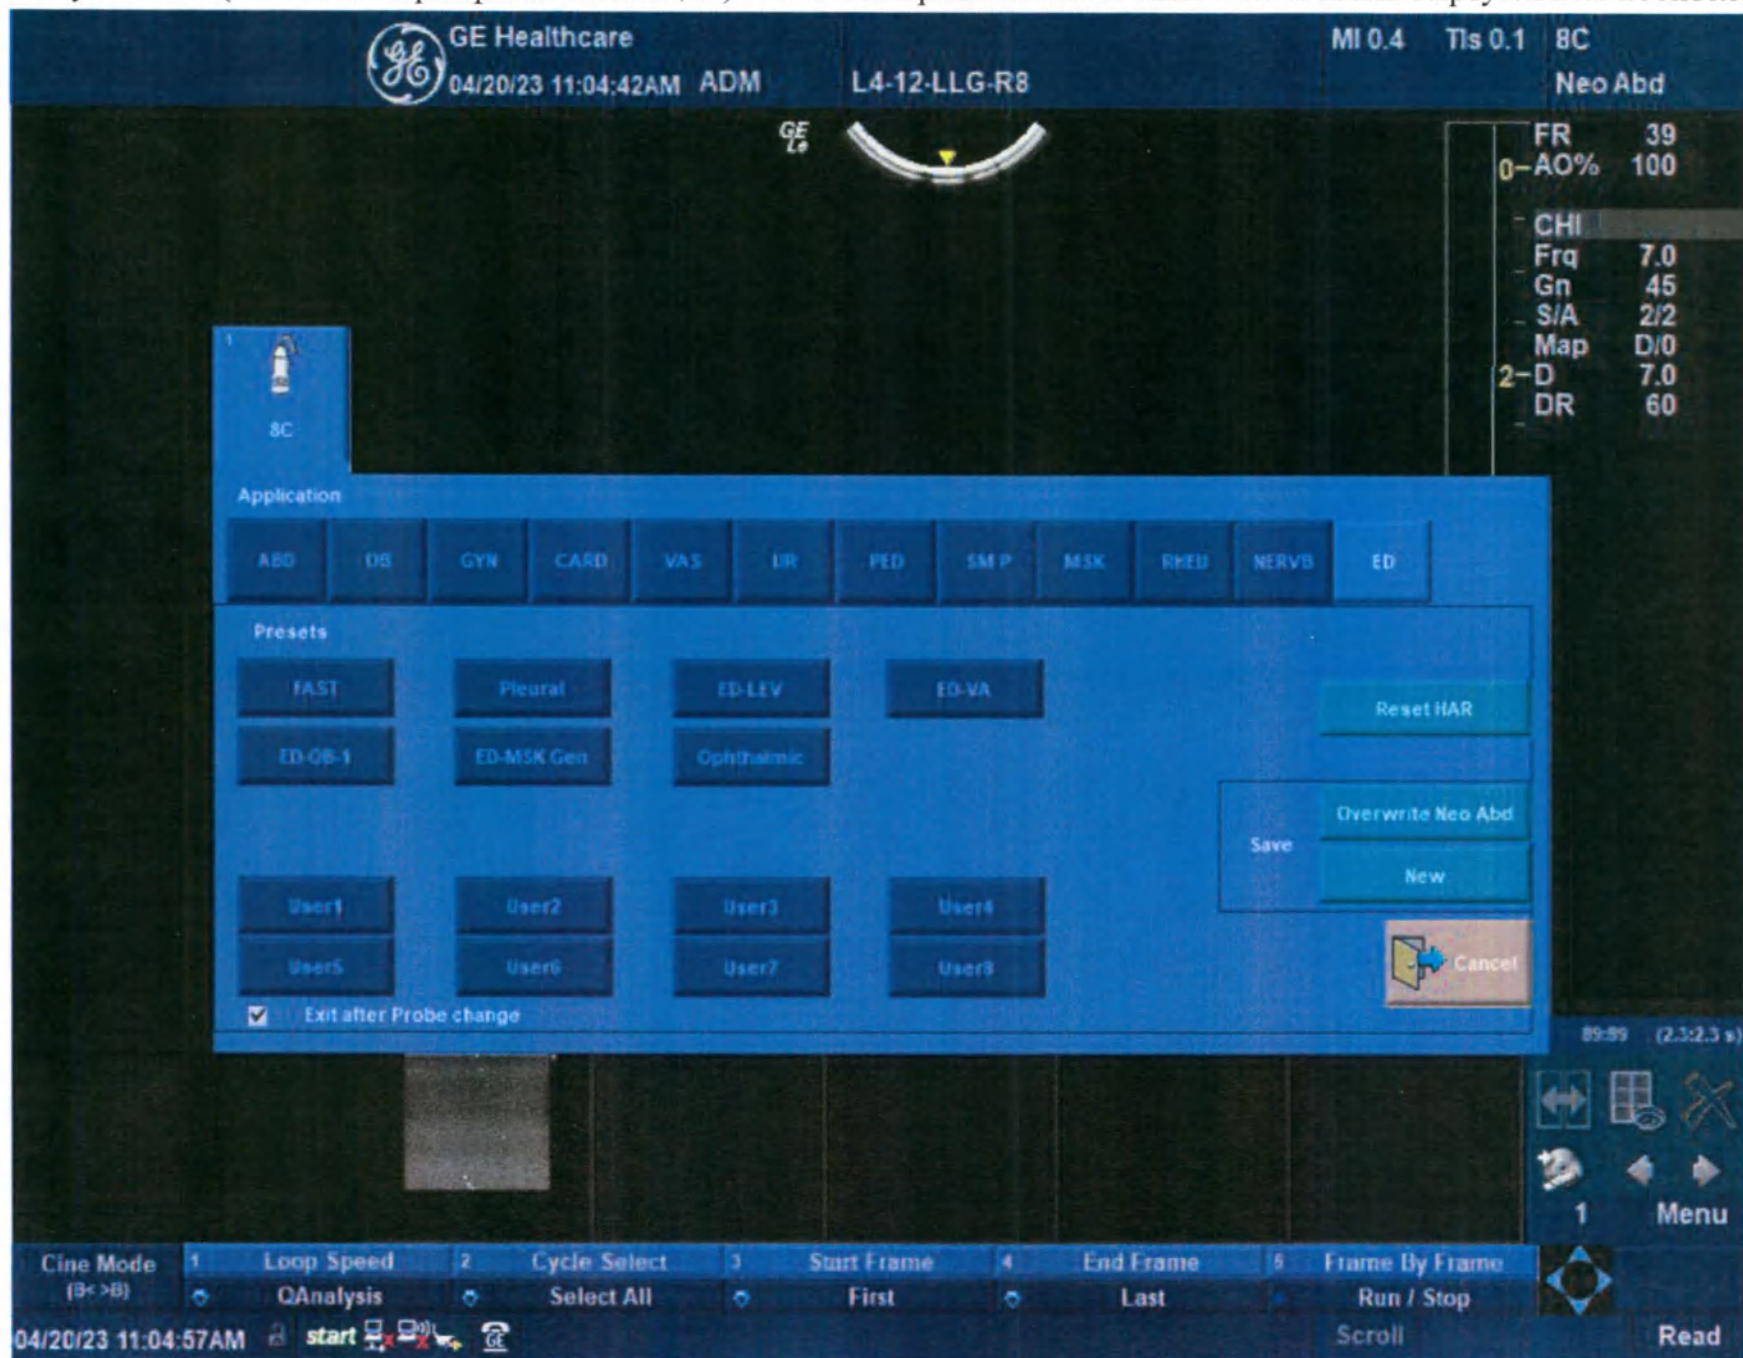

3. Программное обеспечение для ультразвуковых исследований M16-15 probe activation SW option, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




4. Руководство пользователя на русском языке.



**Технические
публикации**

Документ 5561645-145, на русском языке

Ред. 8



LOGIQ e — руководство пользователя

Версии R8.x.x, R9.x.x, R10.x.x


Техническая документация

© 2015-2022 General Electric Co.


5. Руководство пользователя на английском языке.




6. Расширенное справочное руководство на английском языке.

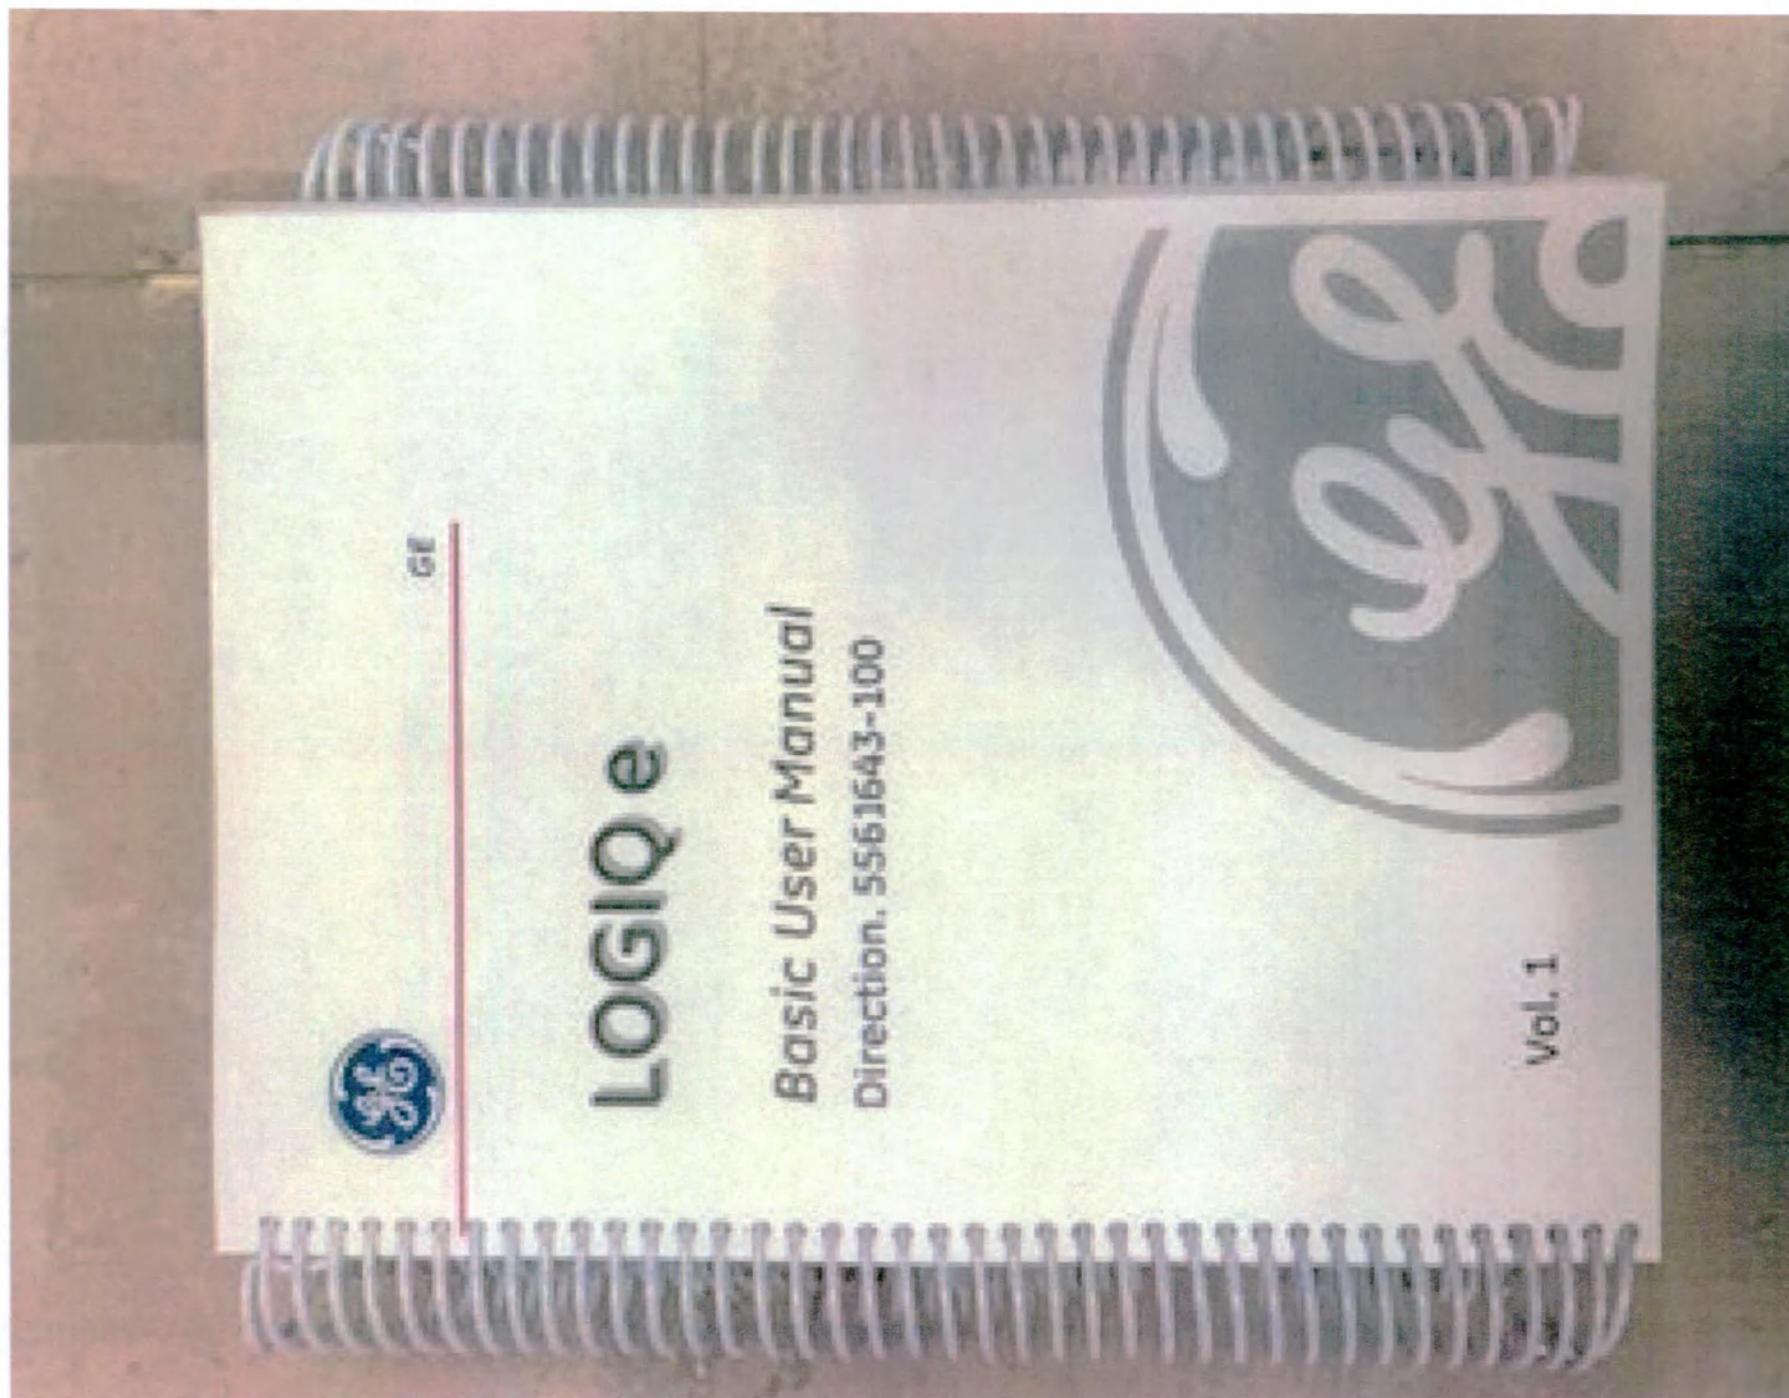

7. Накладки на клавиатуру

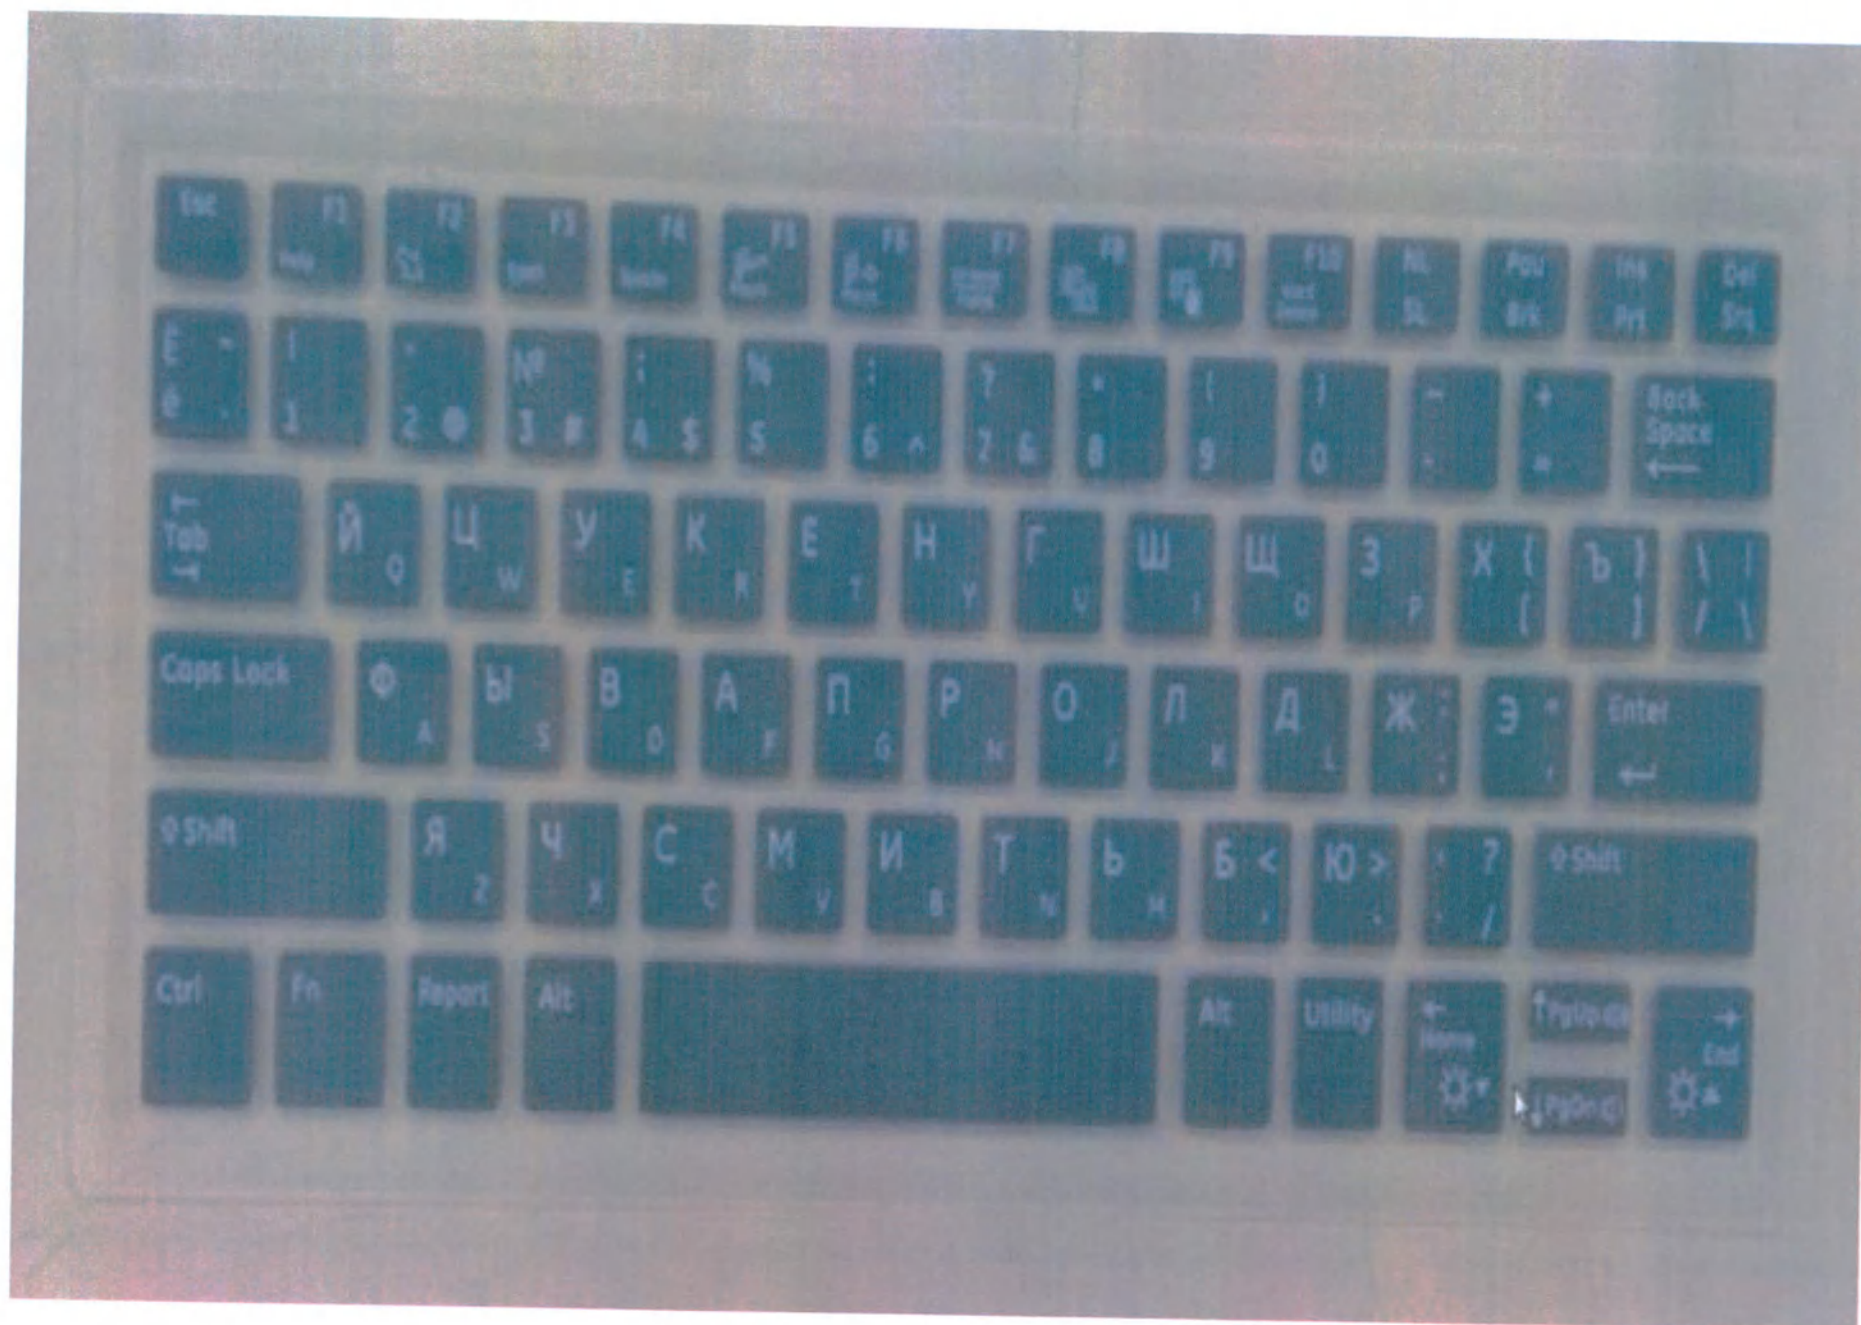


8. Адаптер для проведения биопсий для конвексных датчиков C1-5

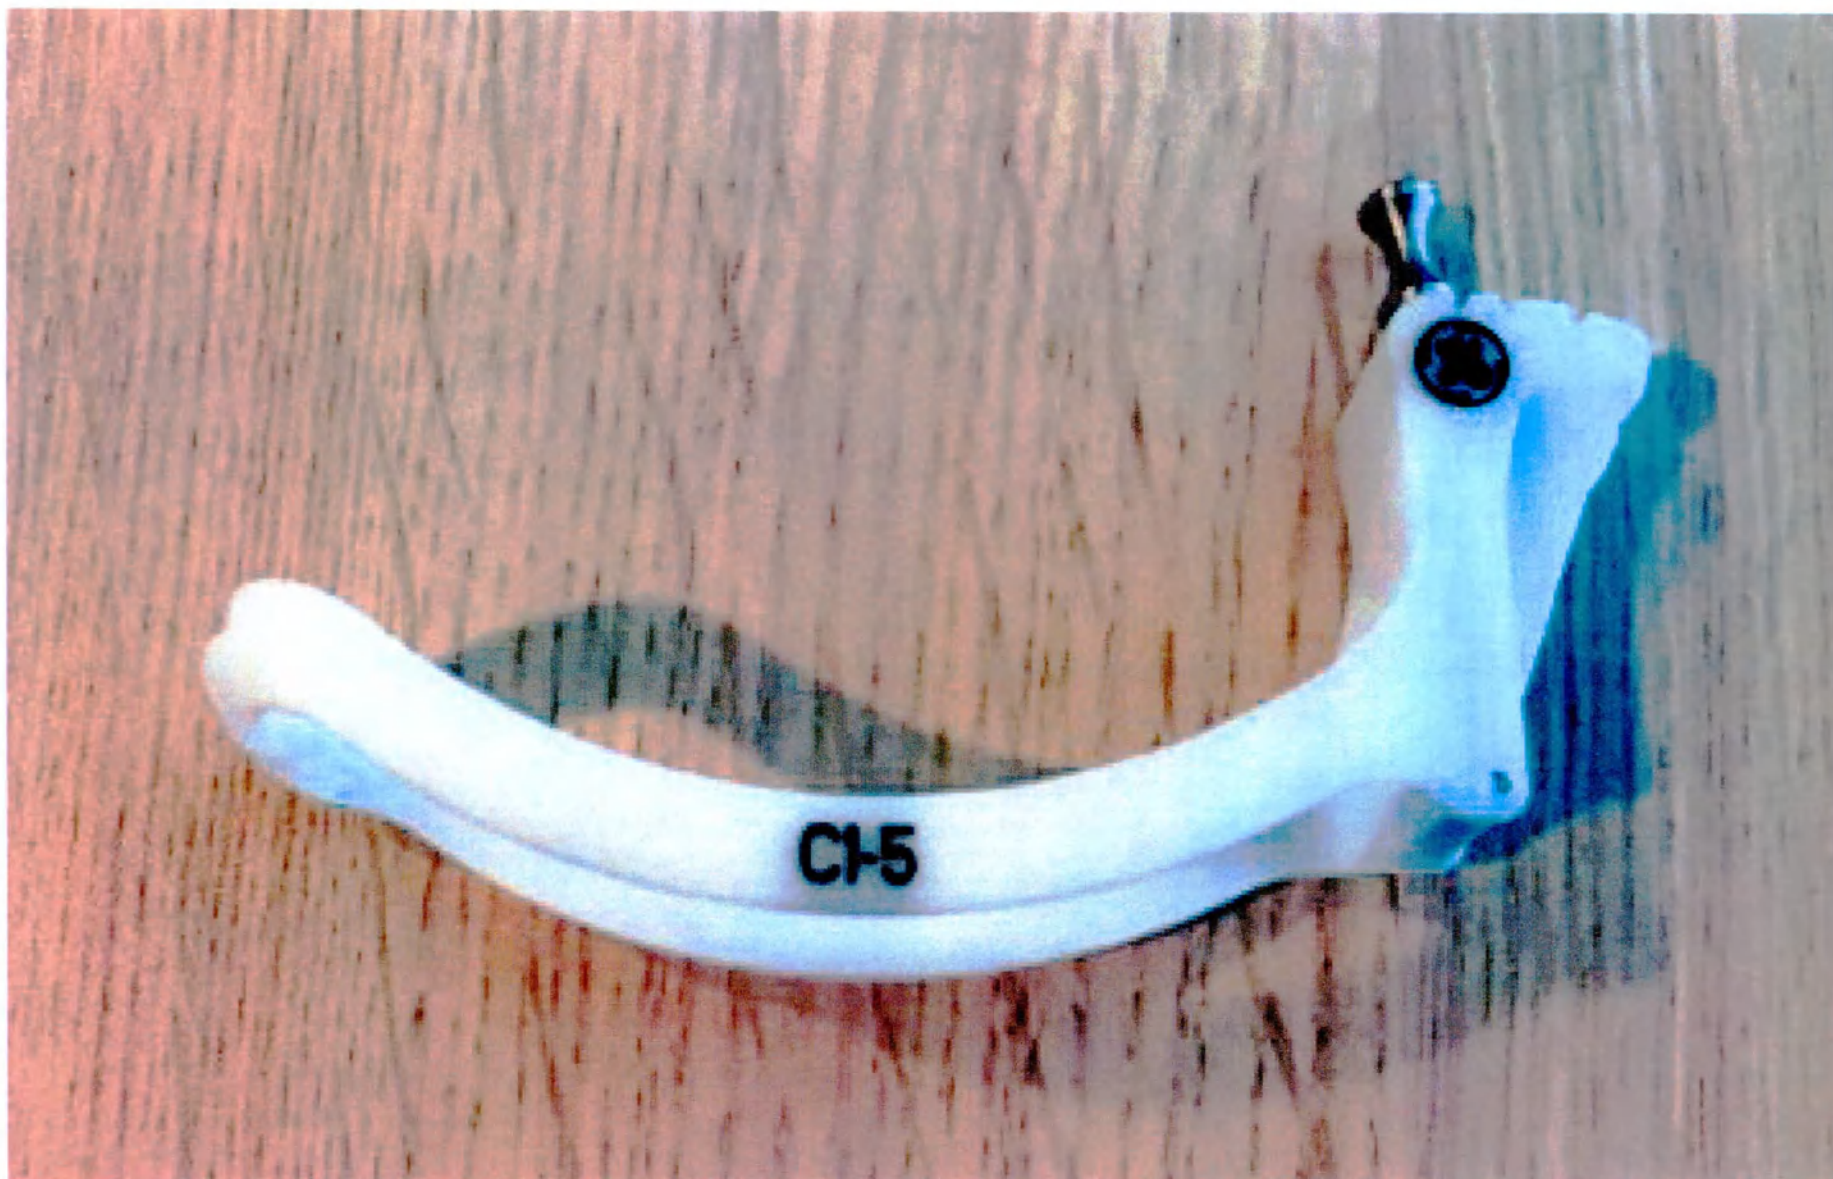

9. Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных внутрисполостных датчиков: 9.1 Адаптер металлический для проведения биопсий для микроконвексных внутрисполостных датчиков E8C




9. Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных внутрисполостных датчиков: 9.2 Адаптер для проведения биопсий для микроконвексных внутрисполостных датчиков Е8С

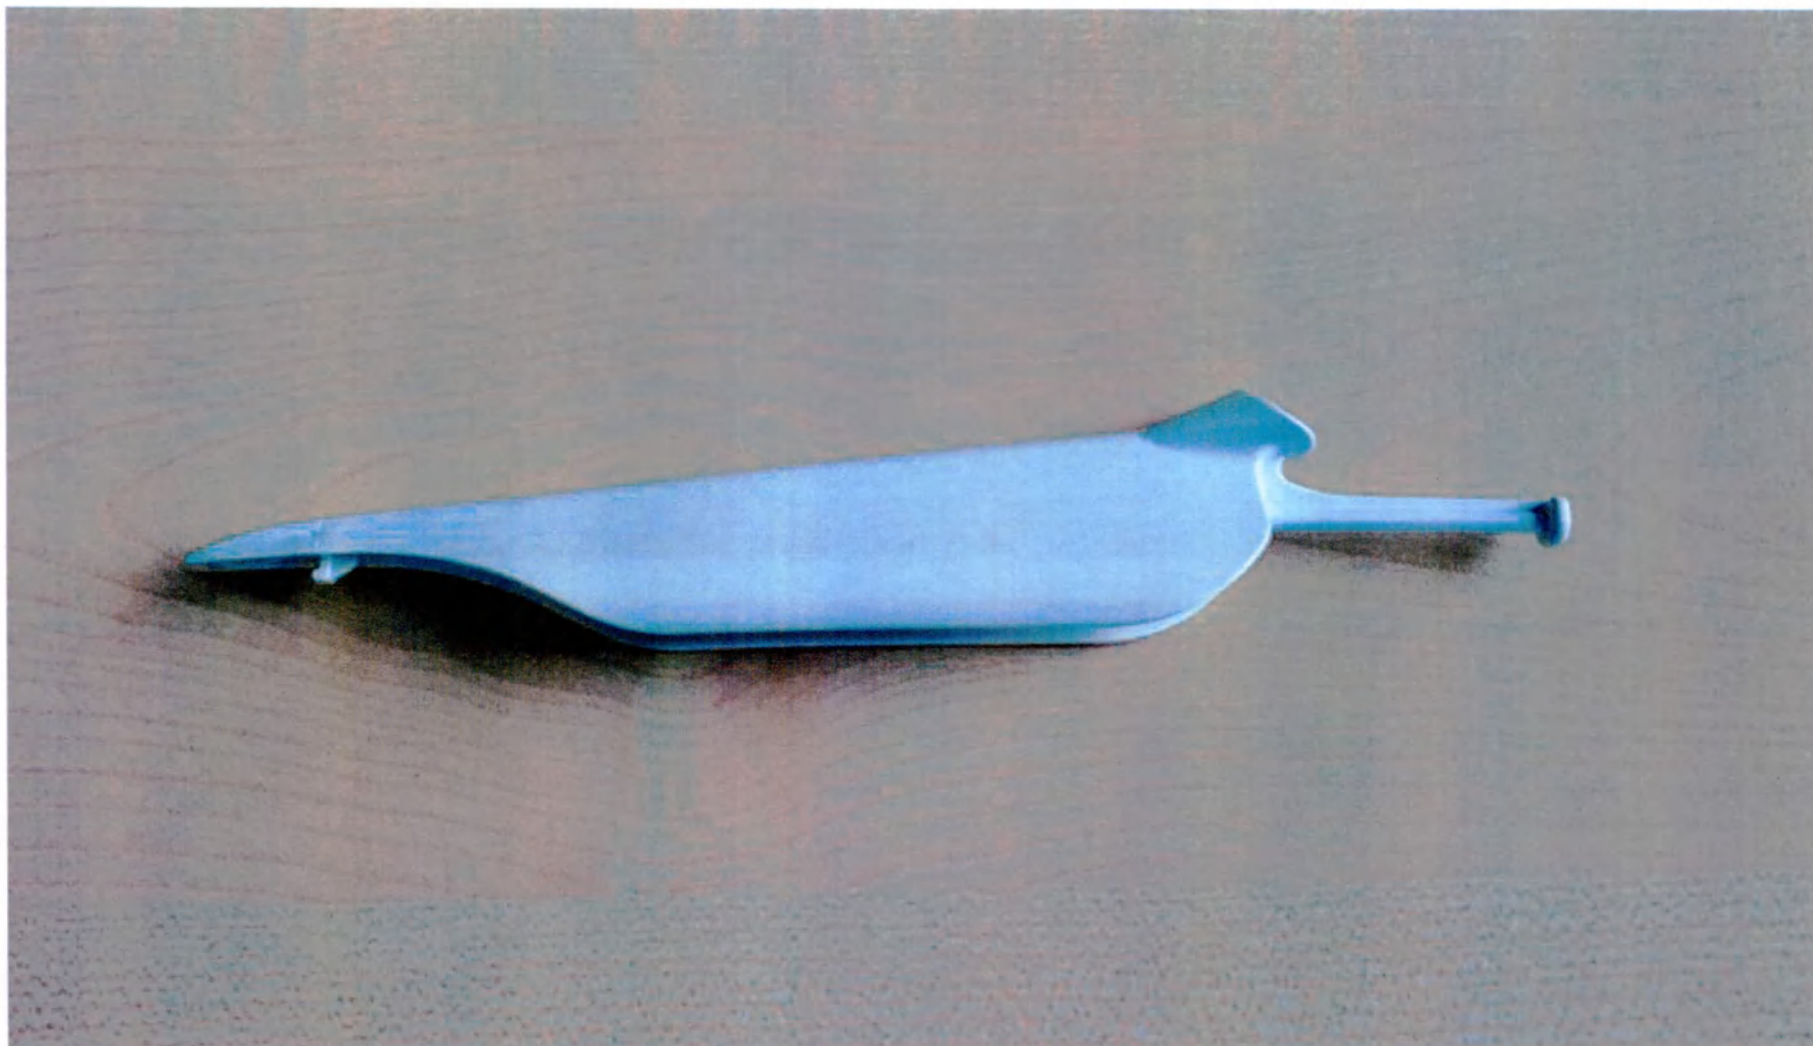

10. Адаптер для проведения биопсии для датчиков линейных матричных ML6-15




11. Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков: 11.1 Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 9L

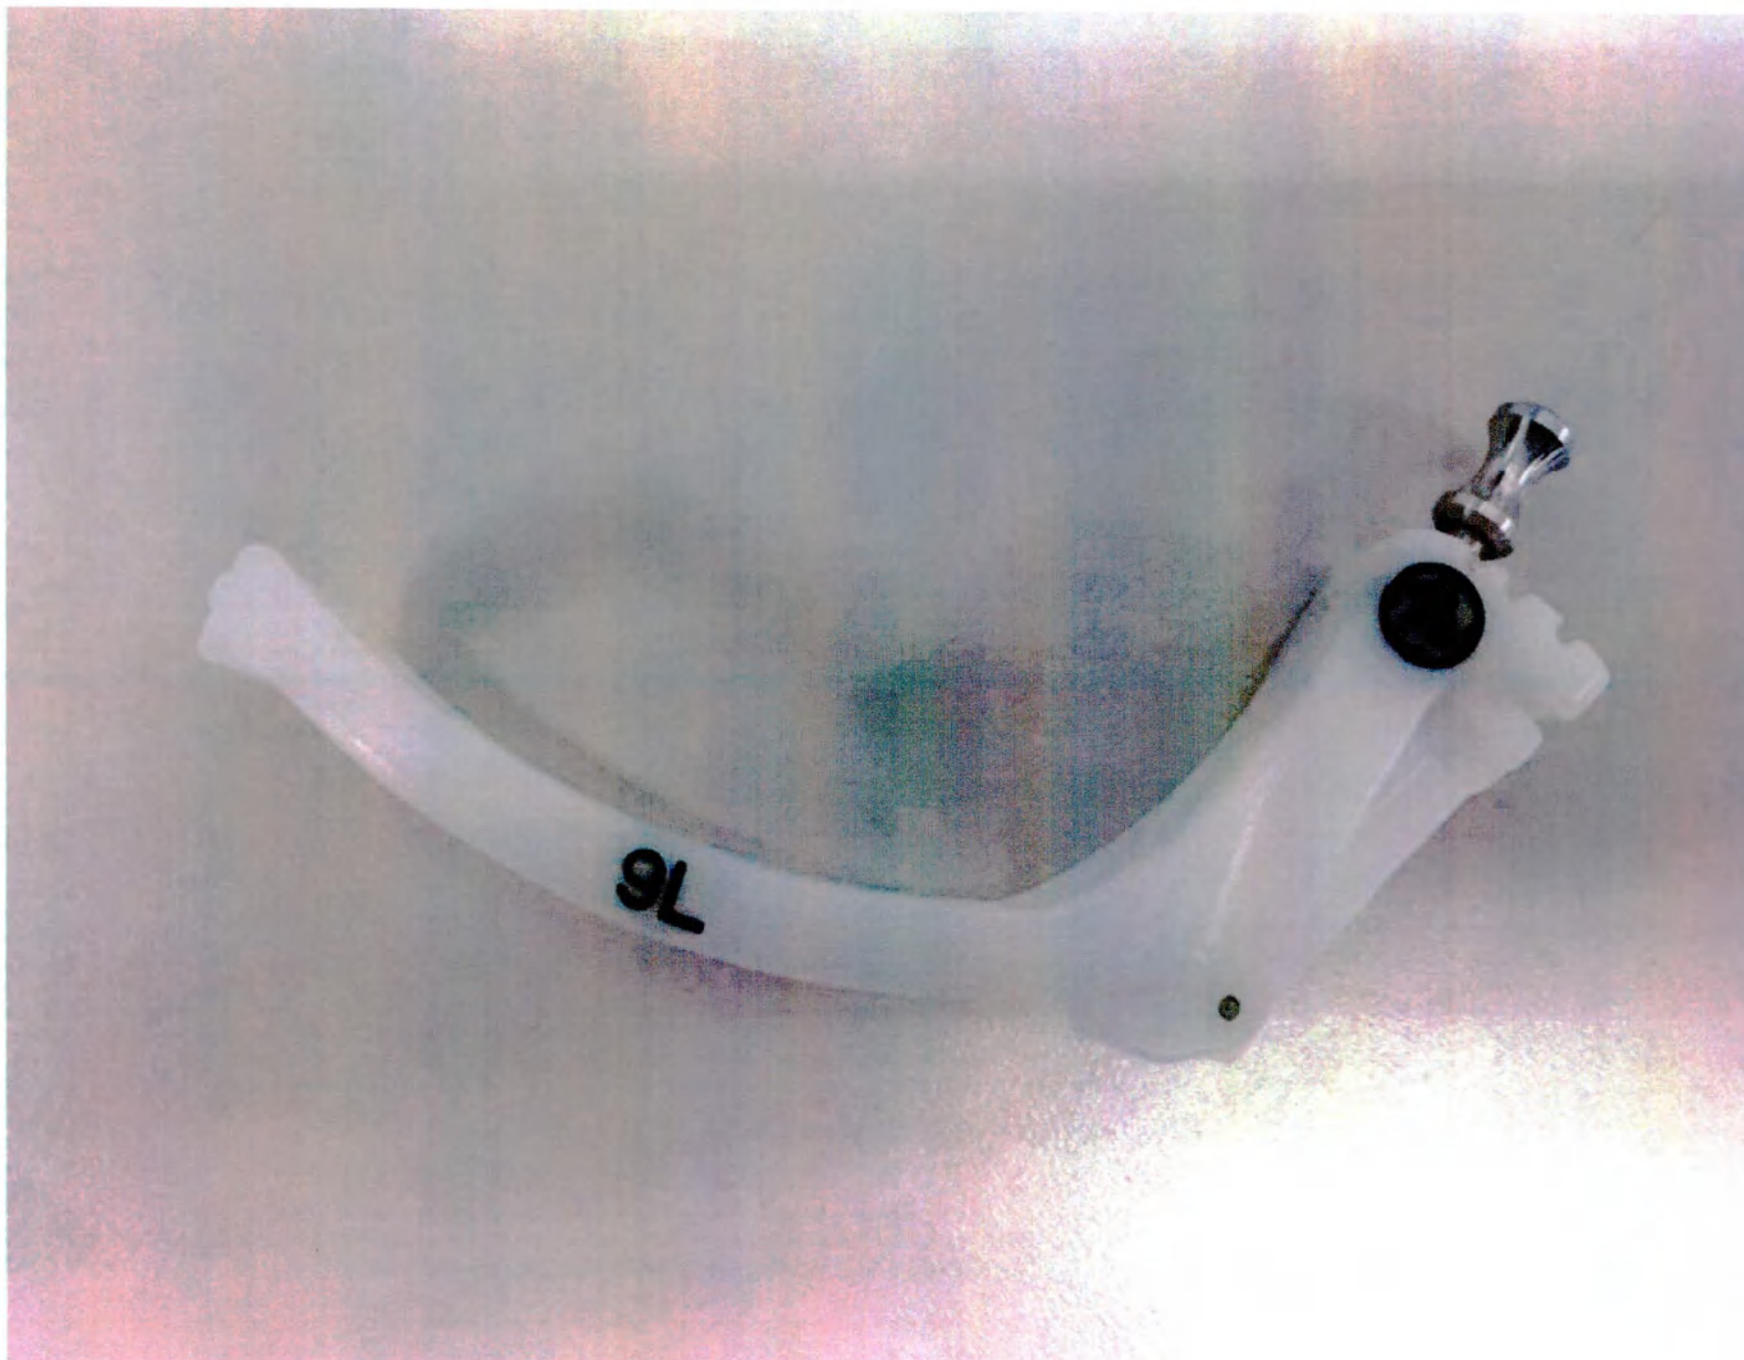

11. Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков: 11.2 Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 11L/12L



11. Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков: 11.3 Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L

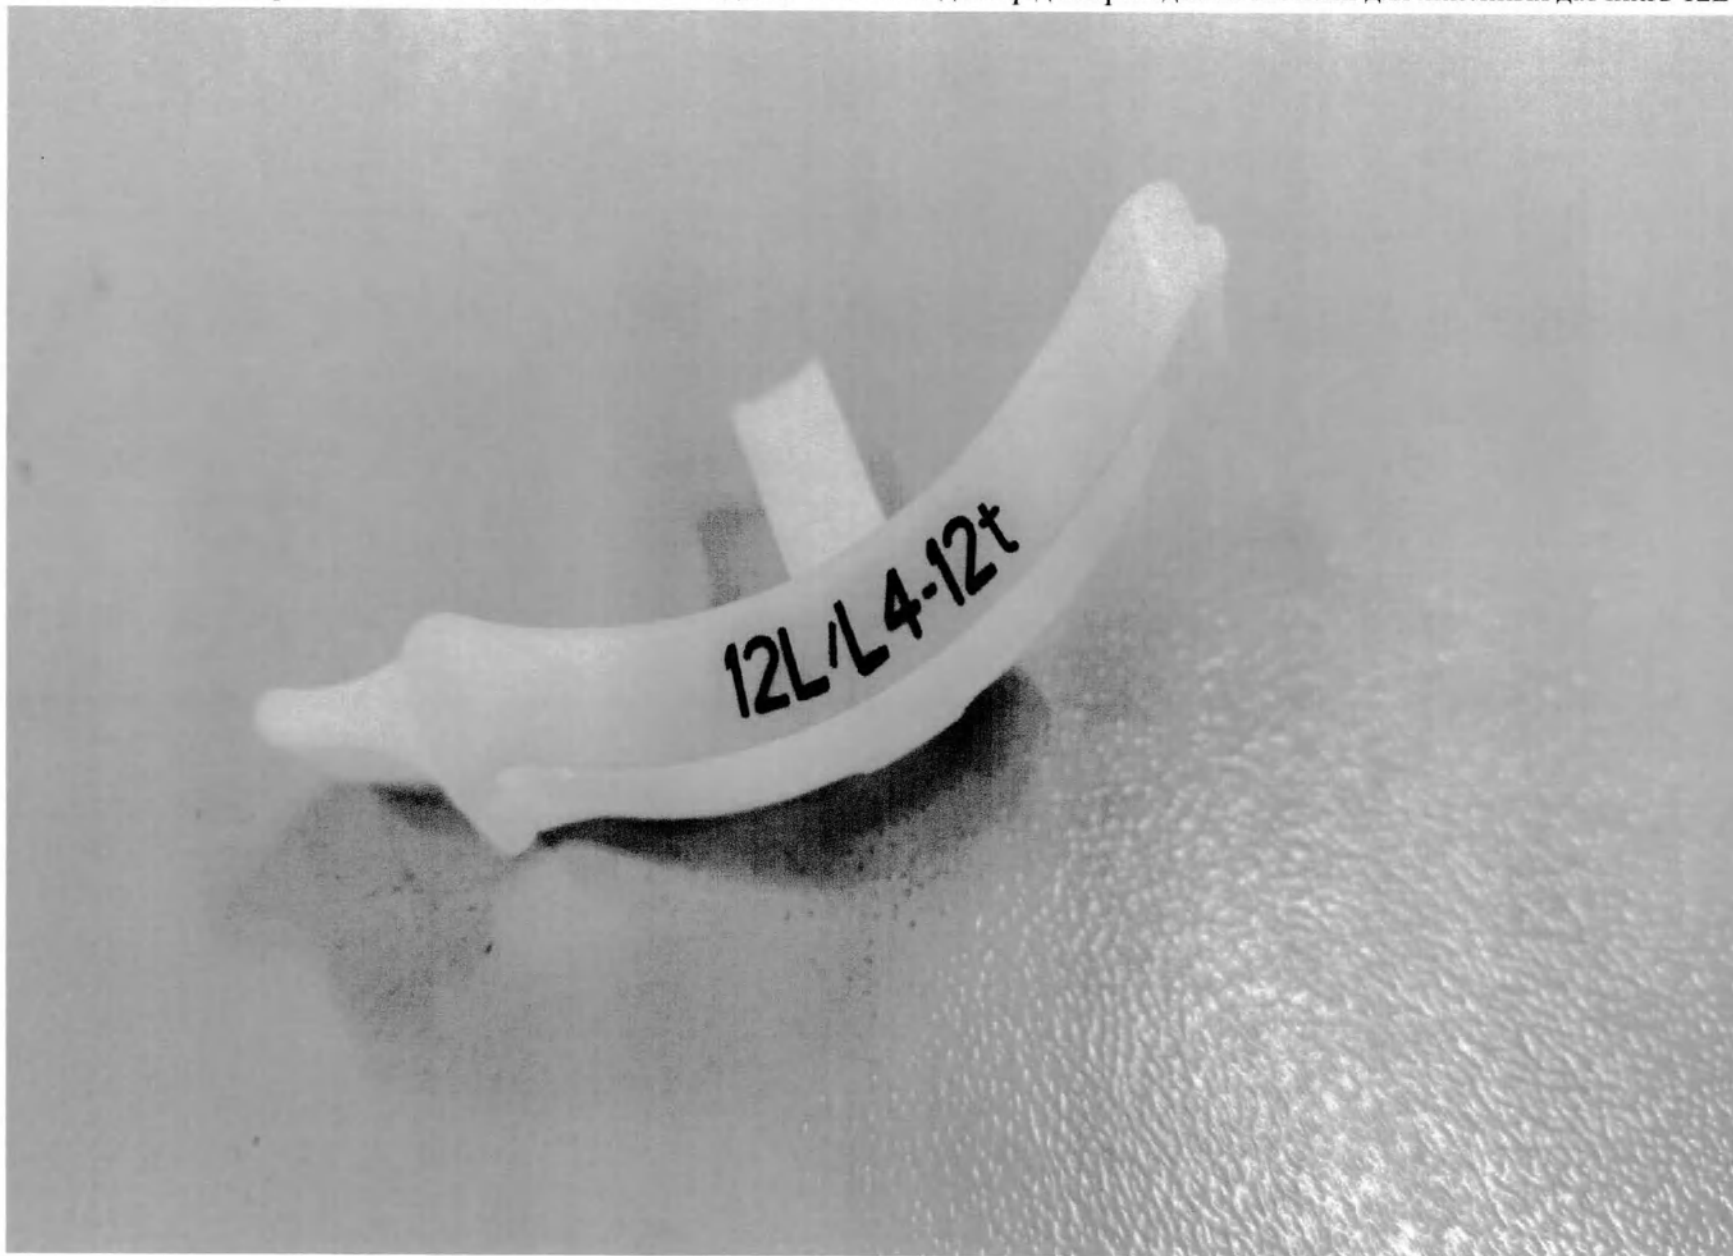


11. Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков: 11.4 Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L-RS




12. Адаптер для проведения биопсий для секторных фазированных датчиков 3Sc



13. Загубники для чреспищеводного датчика: 13.1 Загубник для чреспищеводного датчика Clip-on Biteguard

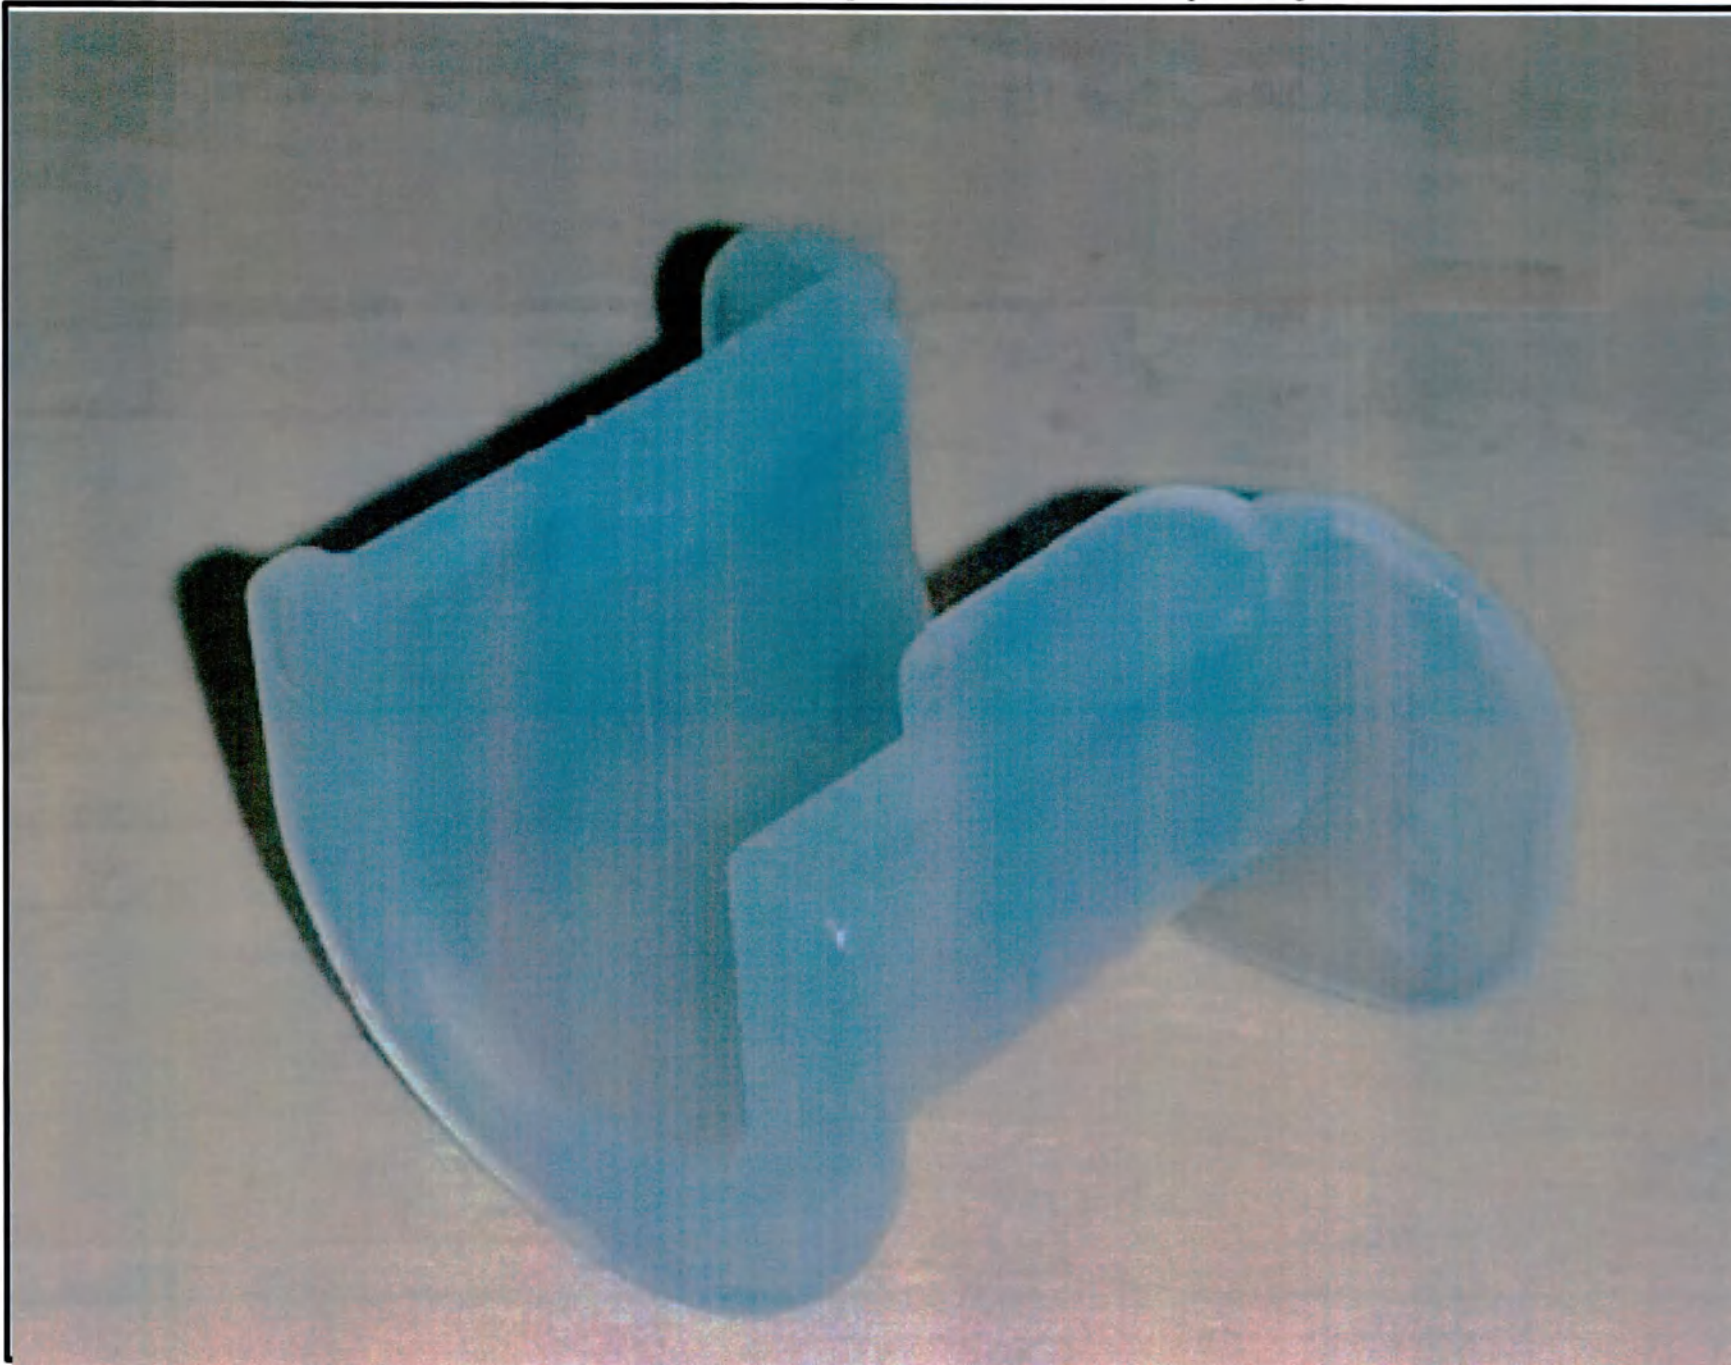


13. Загубники для чреспищеводного датчика: **13.2** Загубник для чреспищеводного датчика Gastroguard

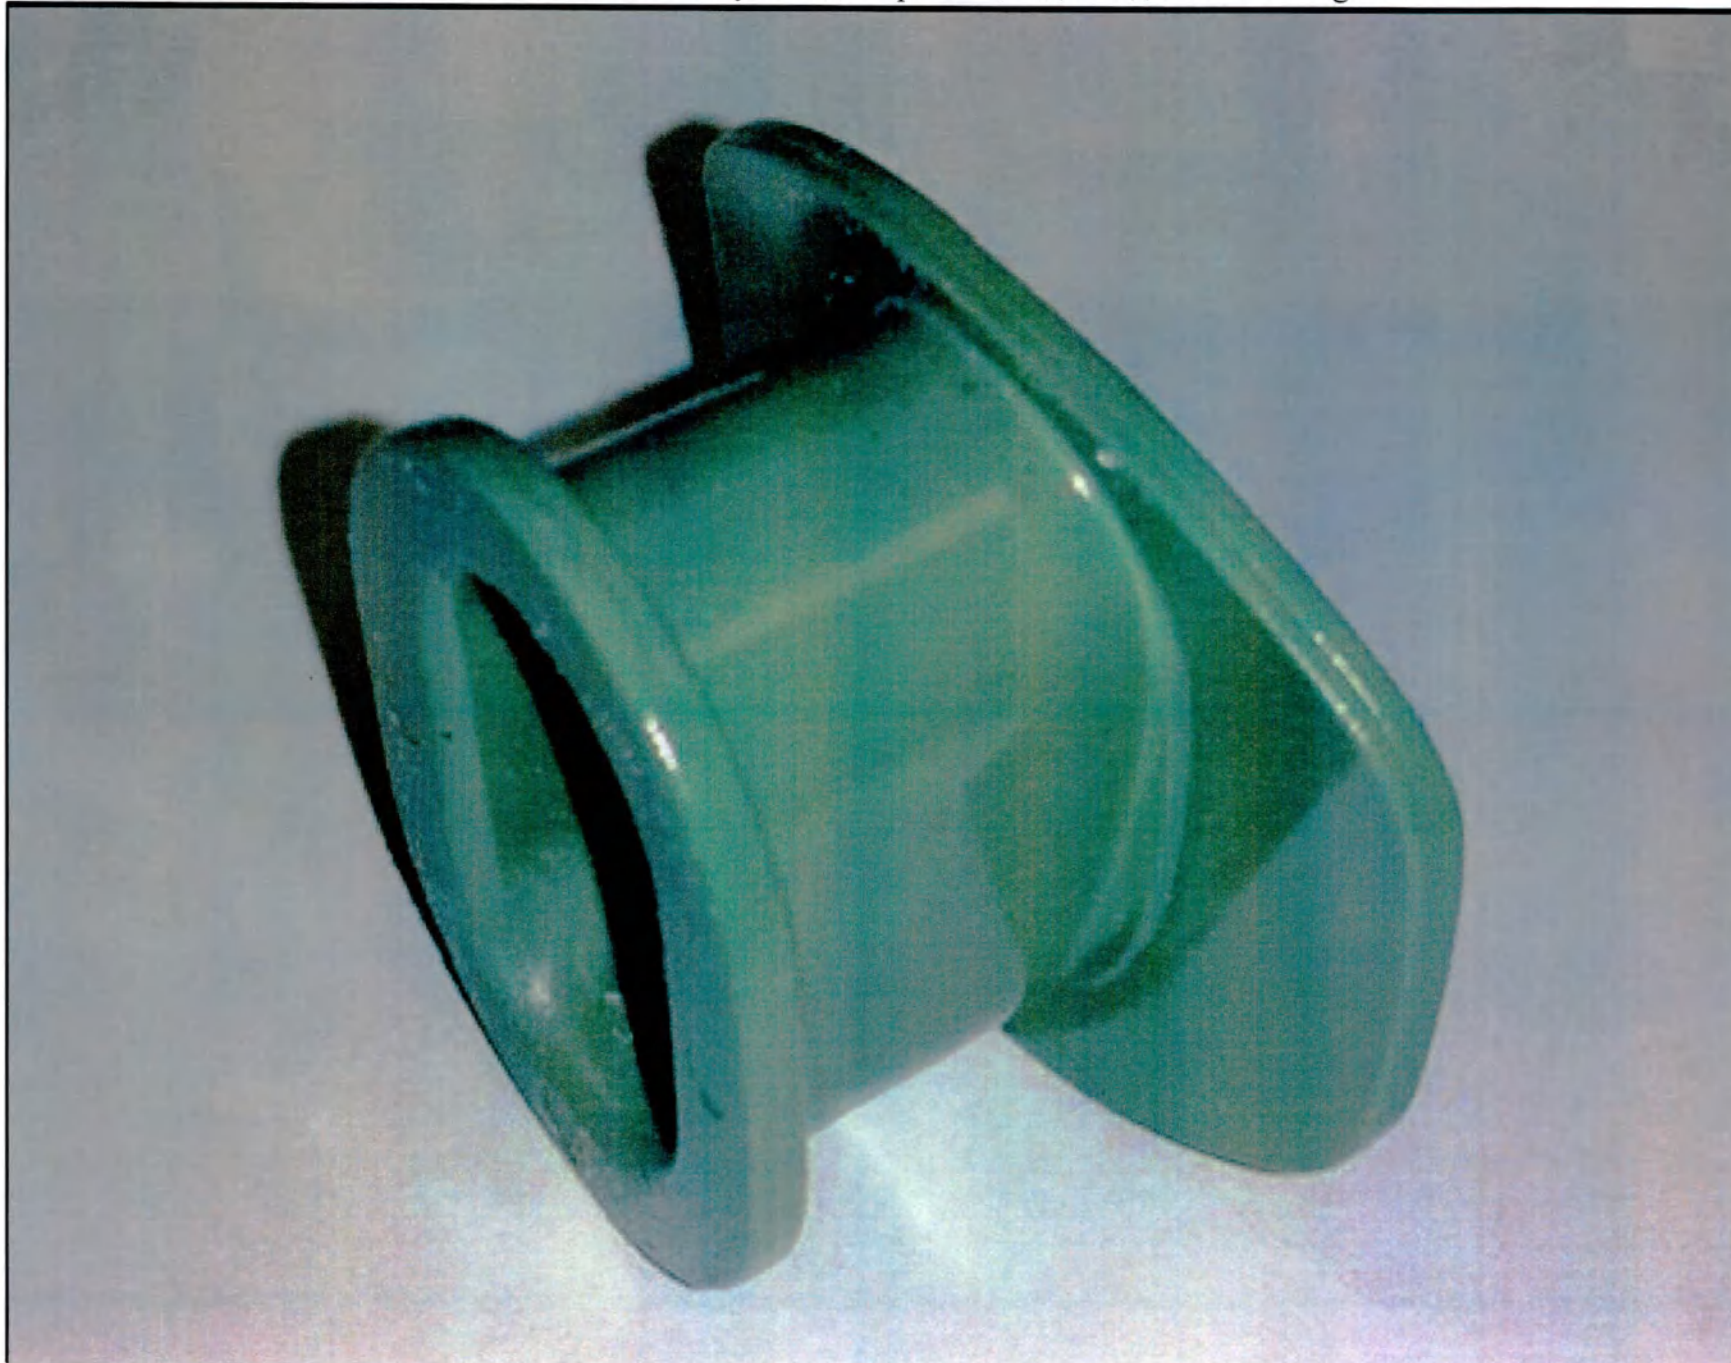

14. Защитный чехол для чреспищеводных датчиков




15. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Easy 3D на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

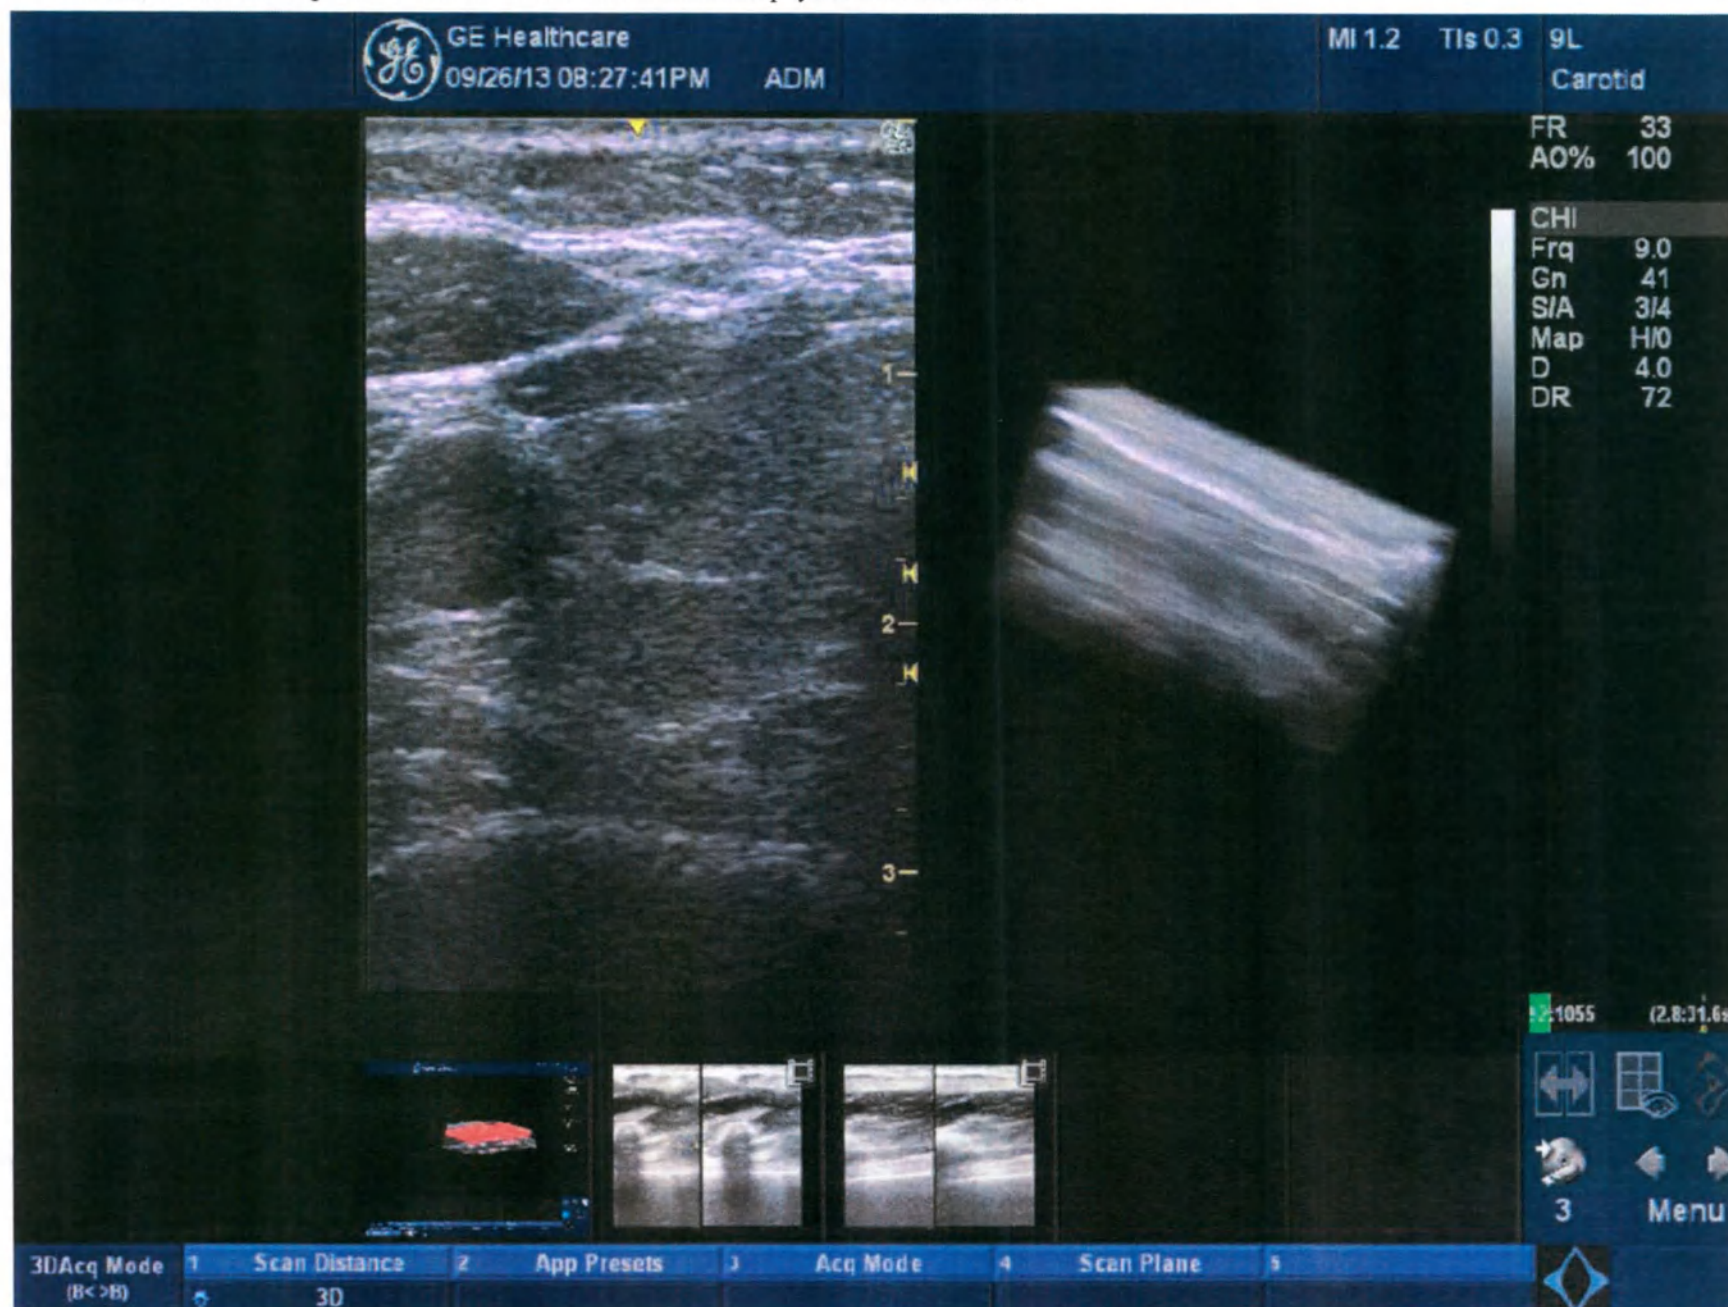


16. Устройство для измерения кровотока - Flow QA на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




17. Устройство для восстановления параметров сканирования пациента - Follow-Up SW Option на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

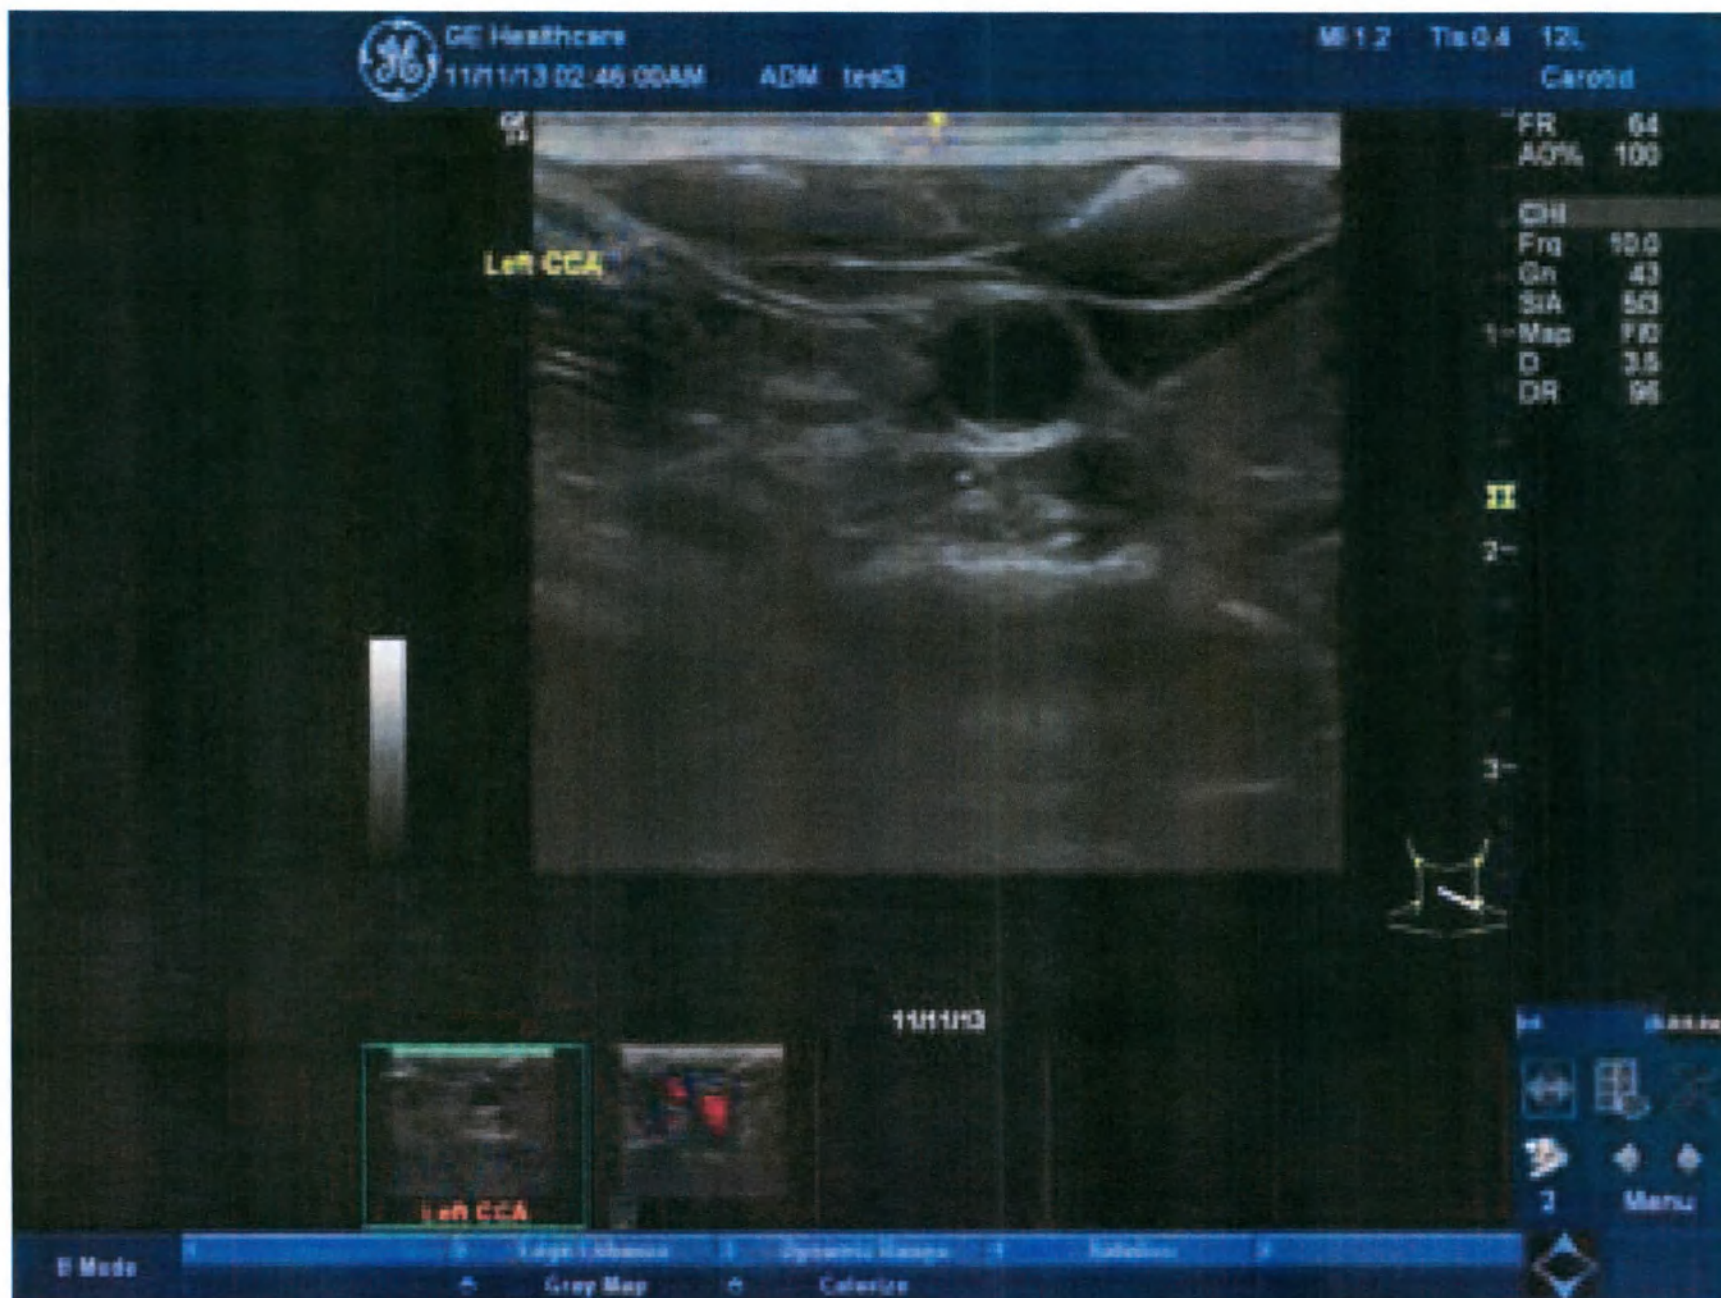


18. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме тканевого доплера - TDI SW Option на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

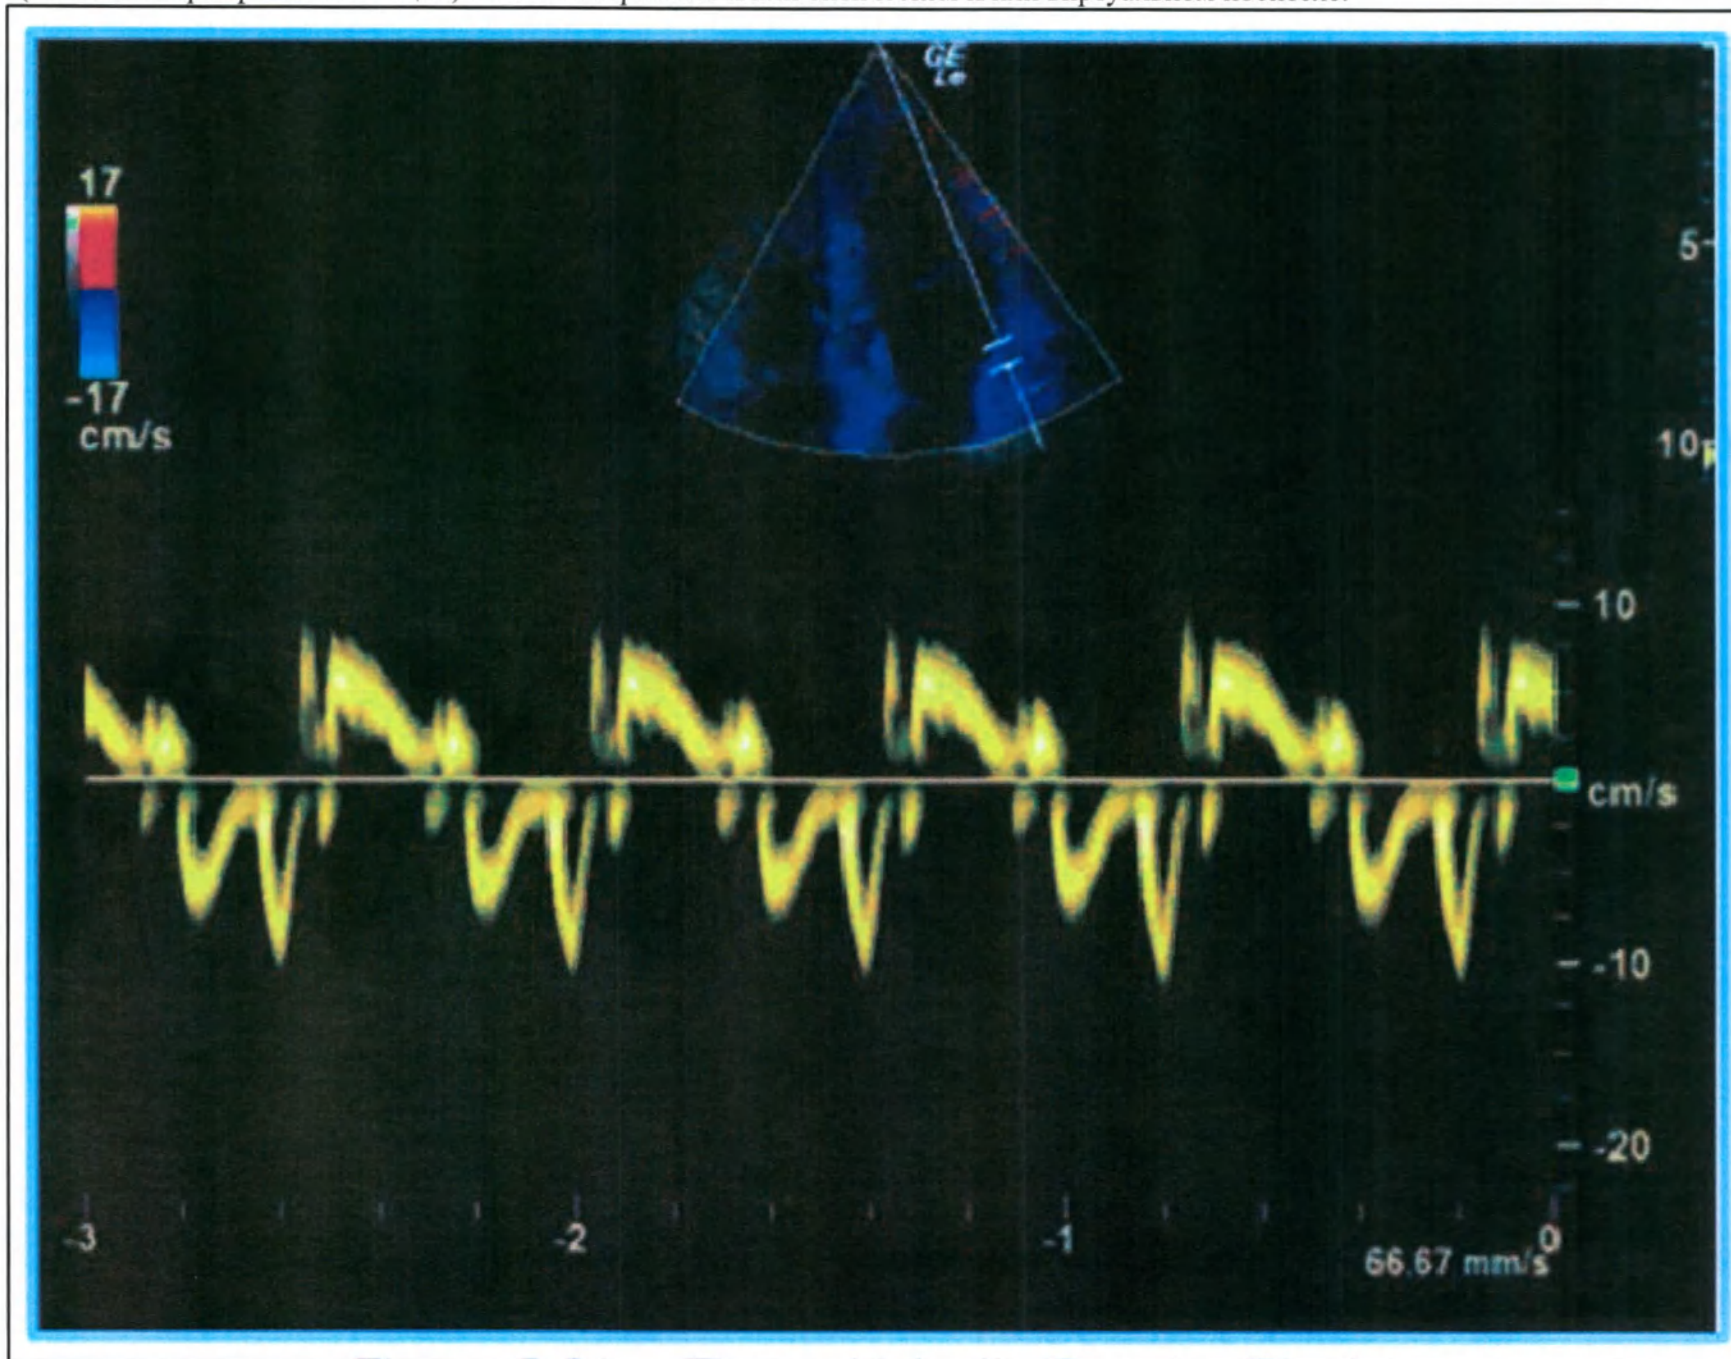


19. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера - CWD kit.

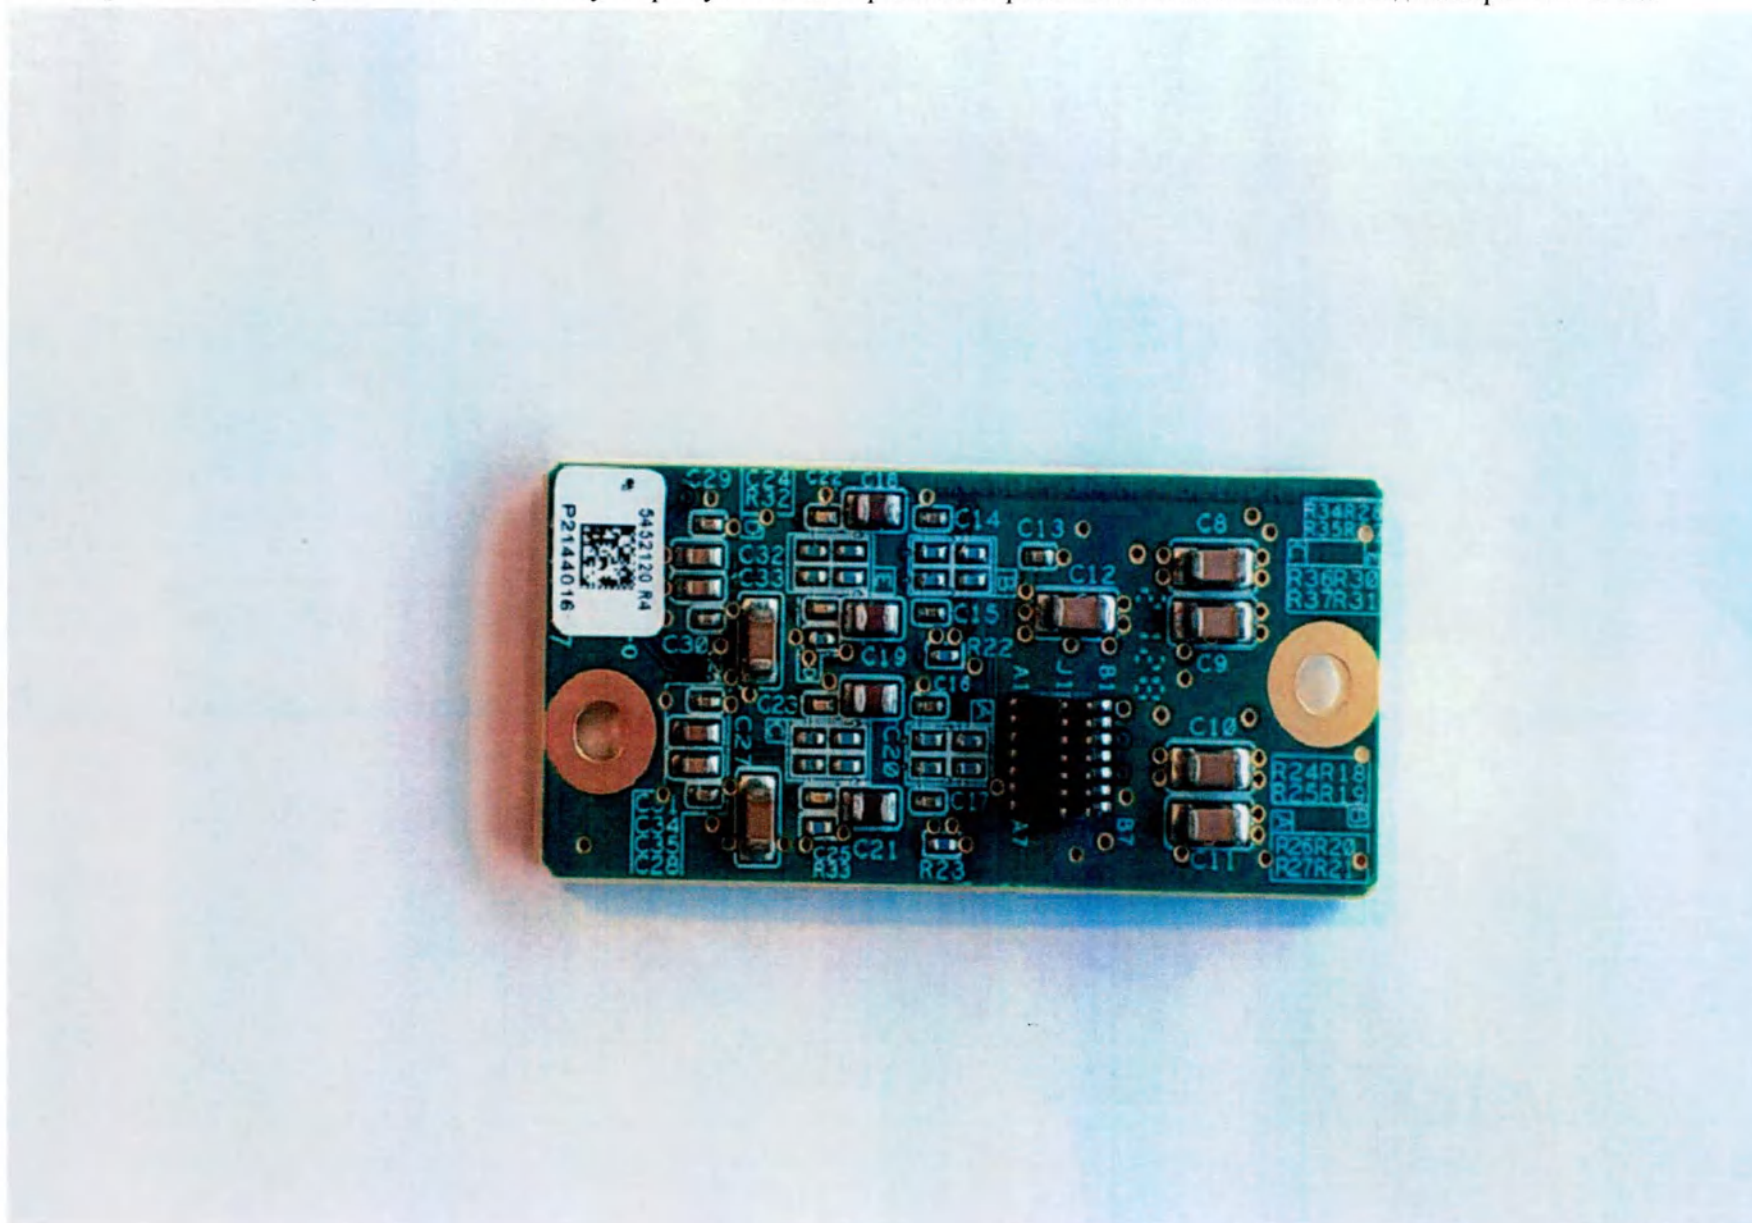


20. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме цветного и анатомического М-режима - Color and Anatomical M-Mode на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

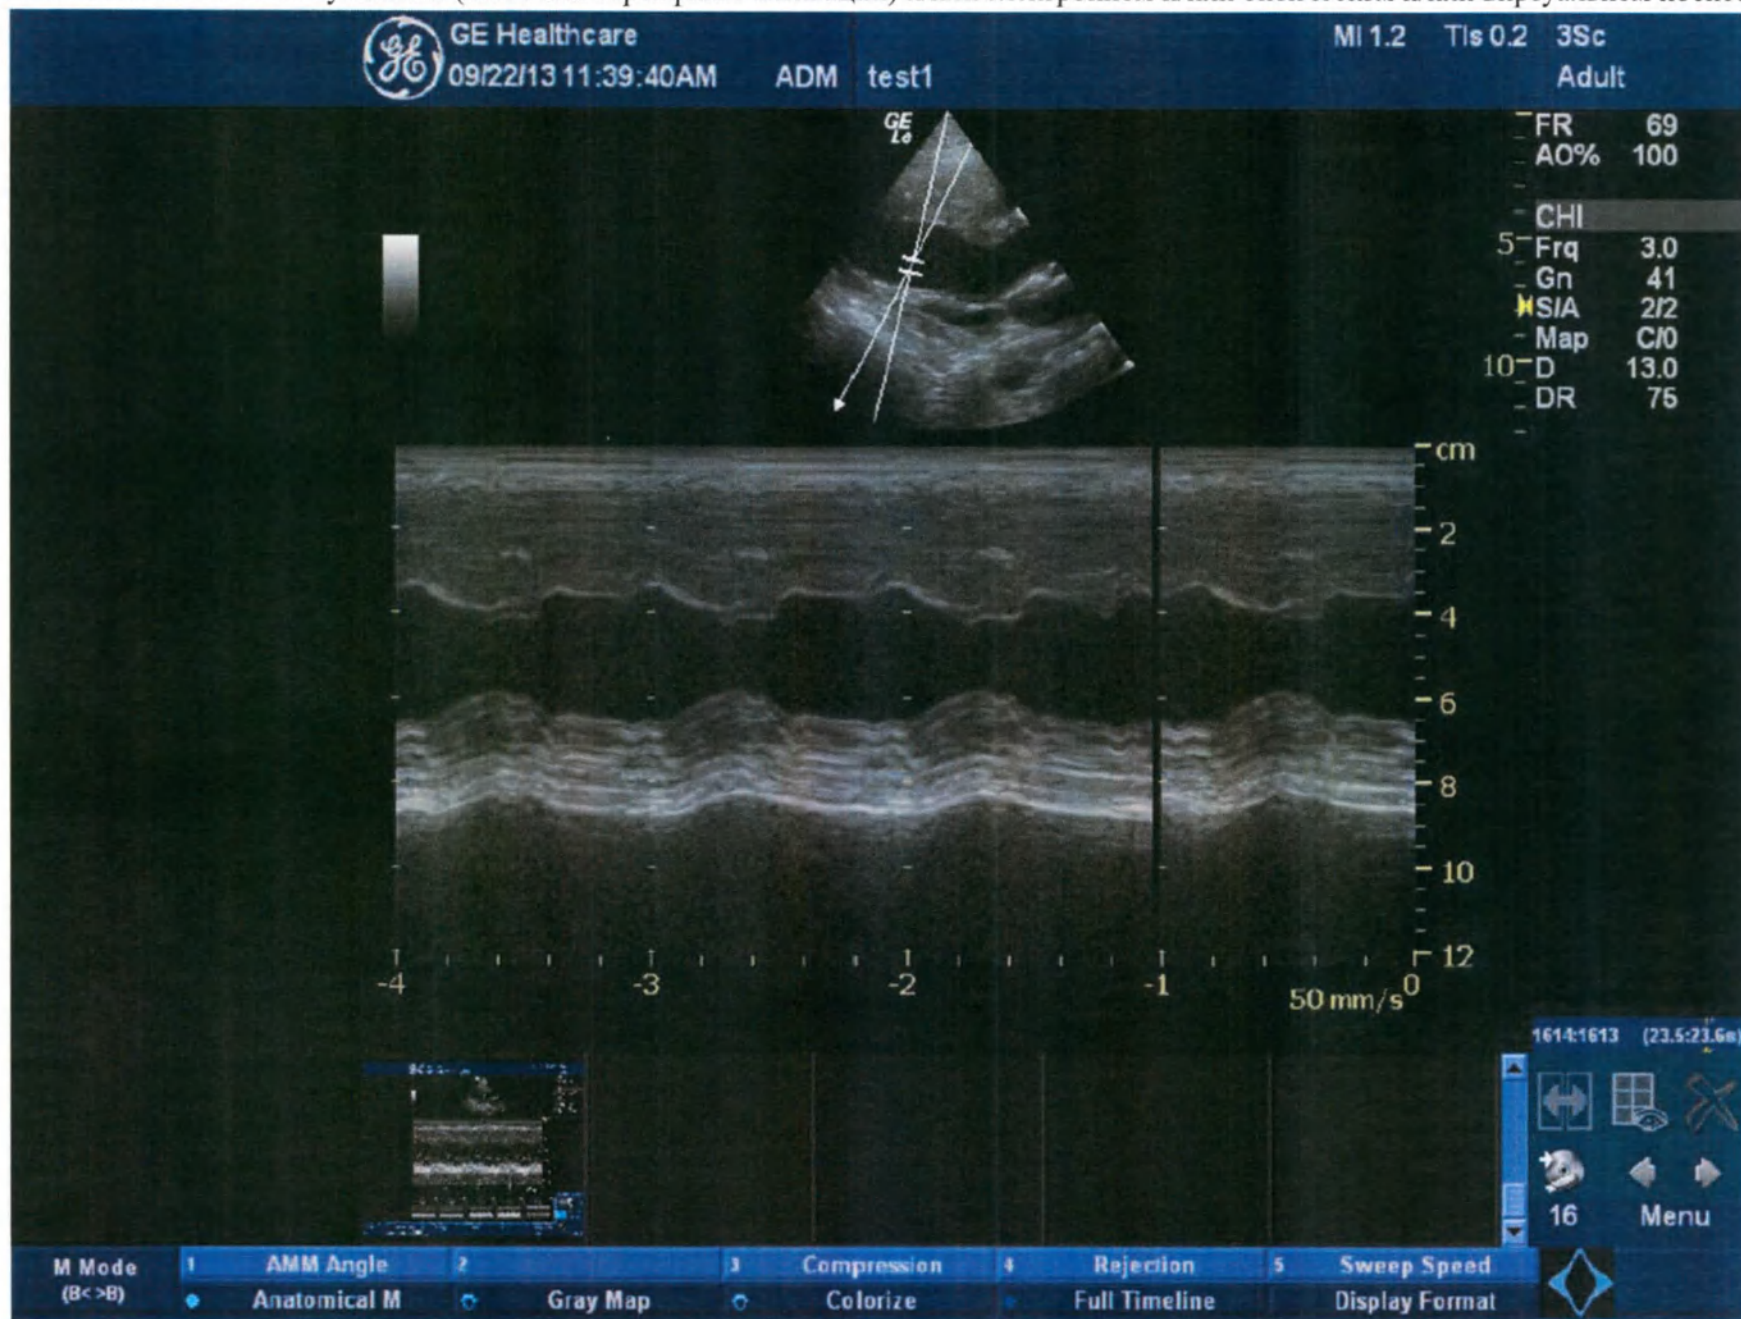

21. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме панорамного сканирования - Logiq View на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

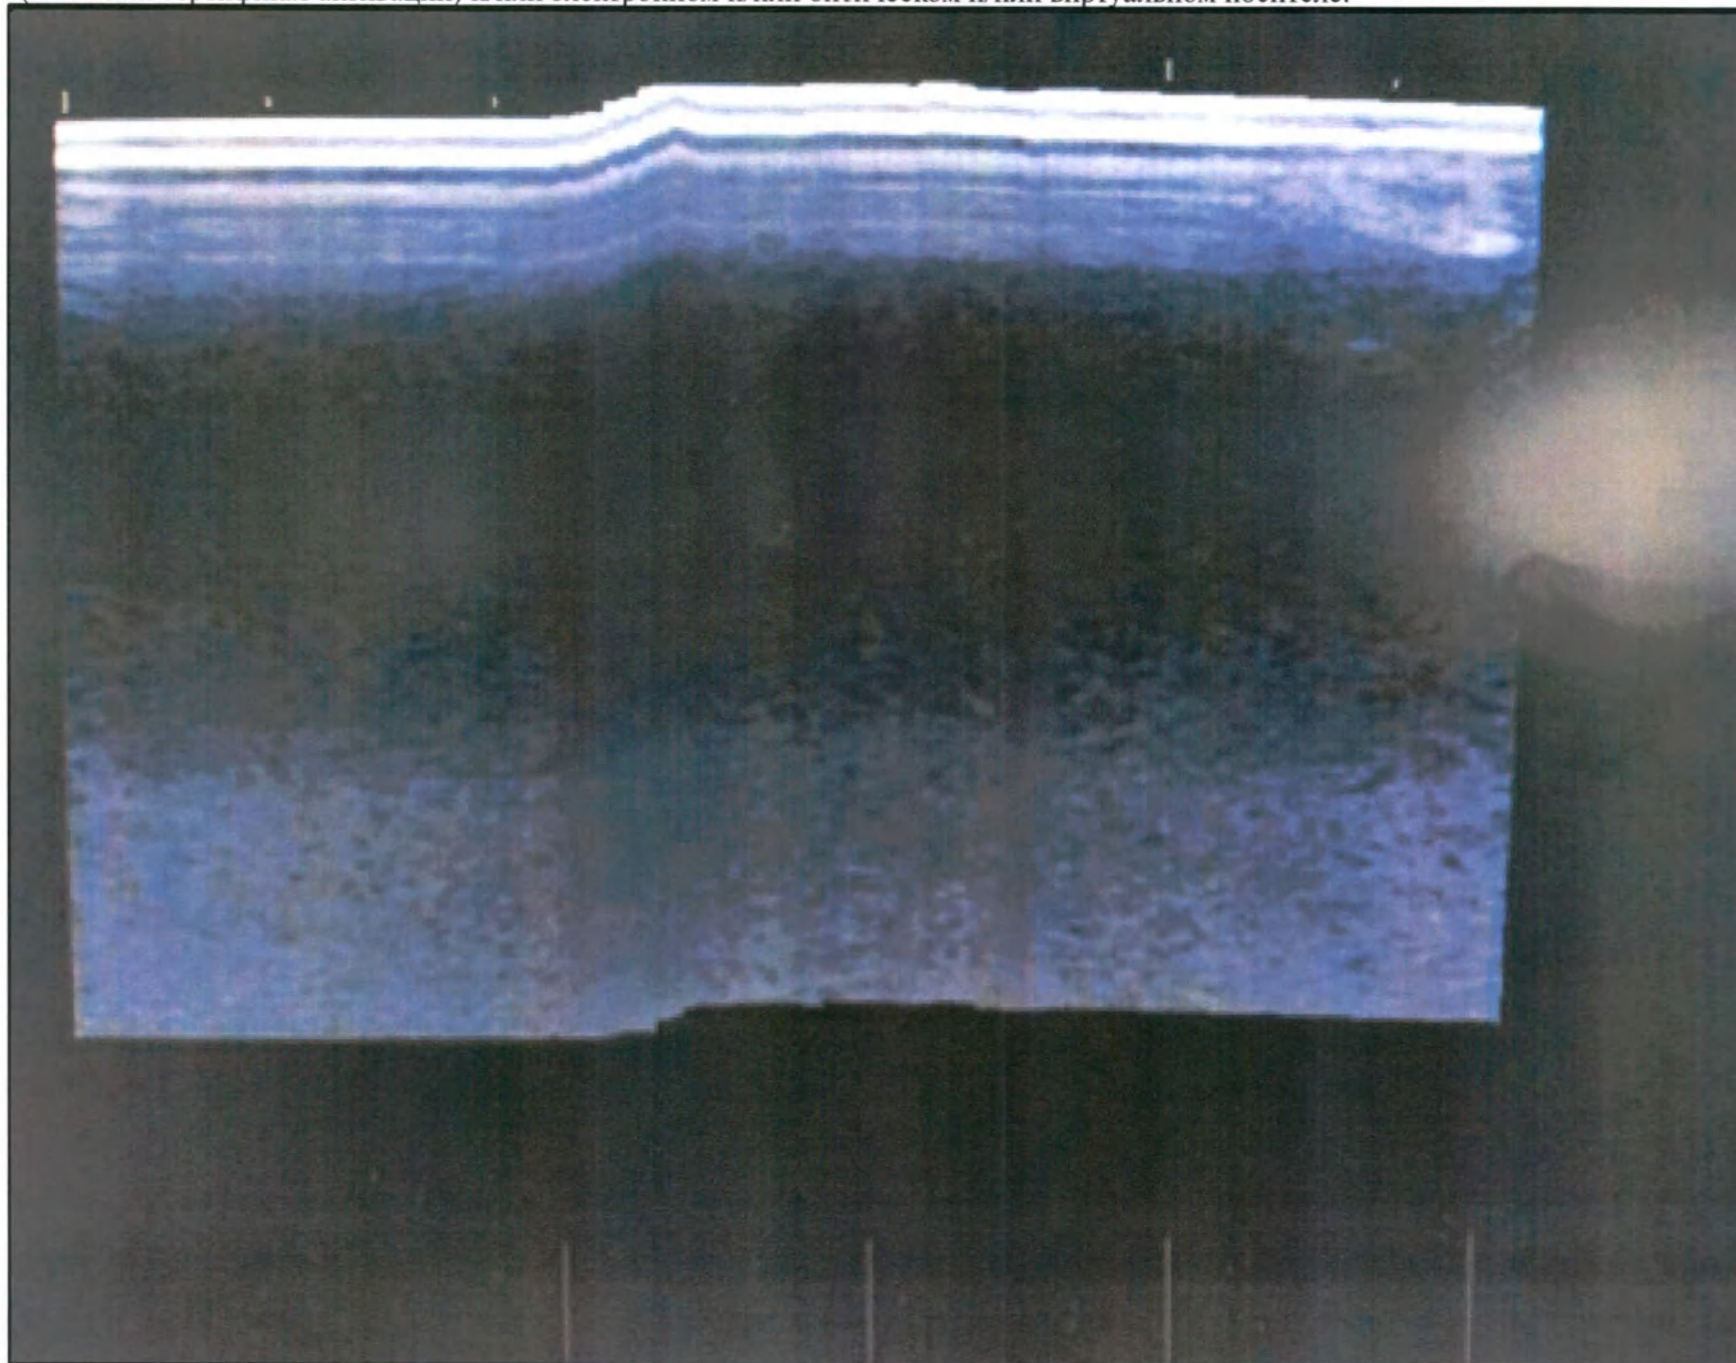


22. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме B-Steer на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

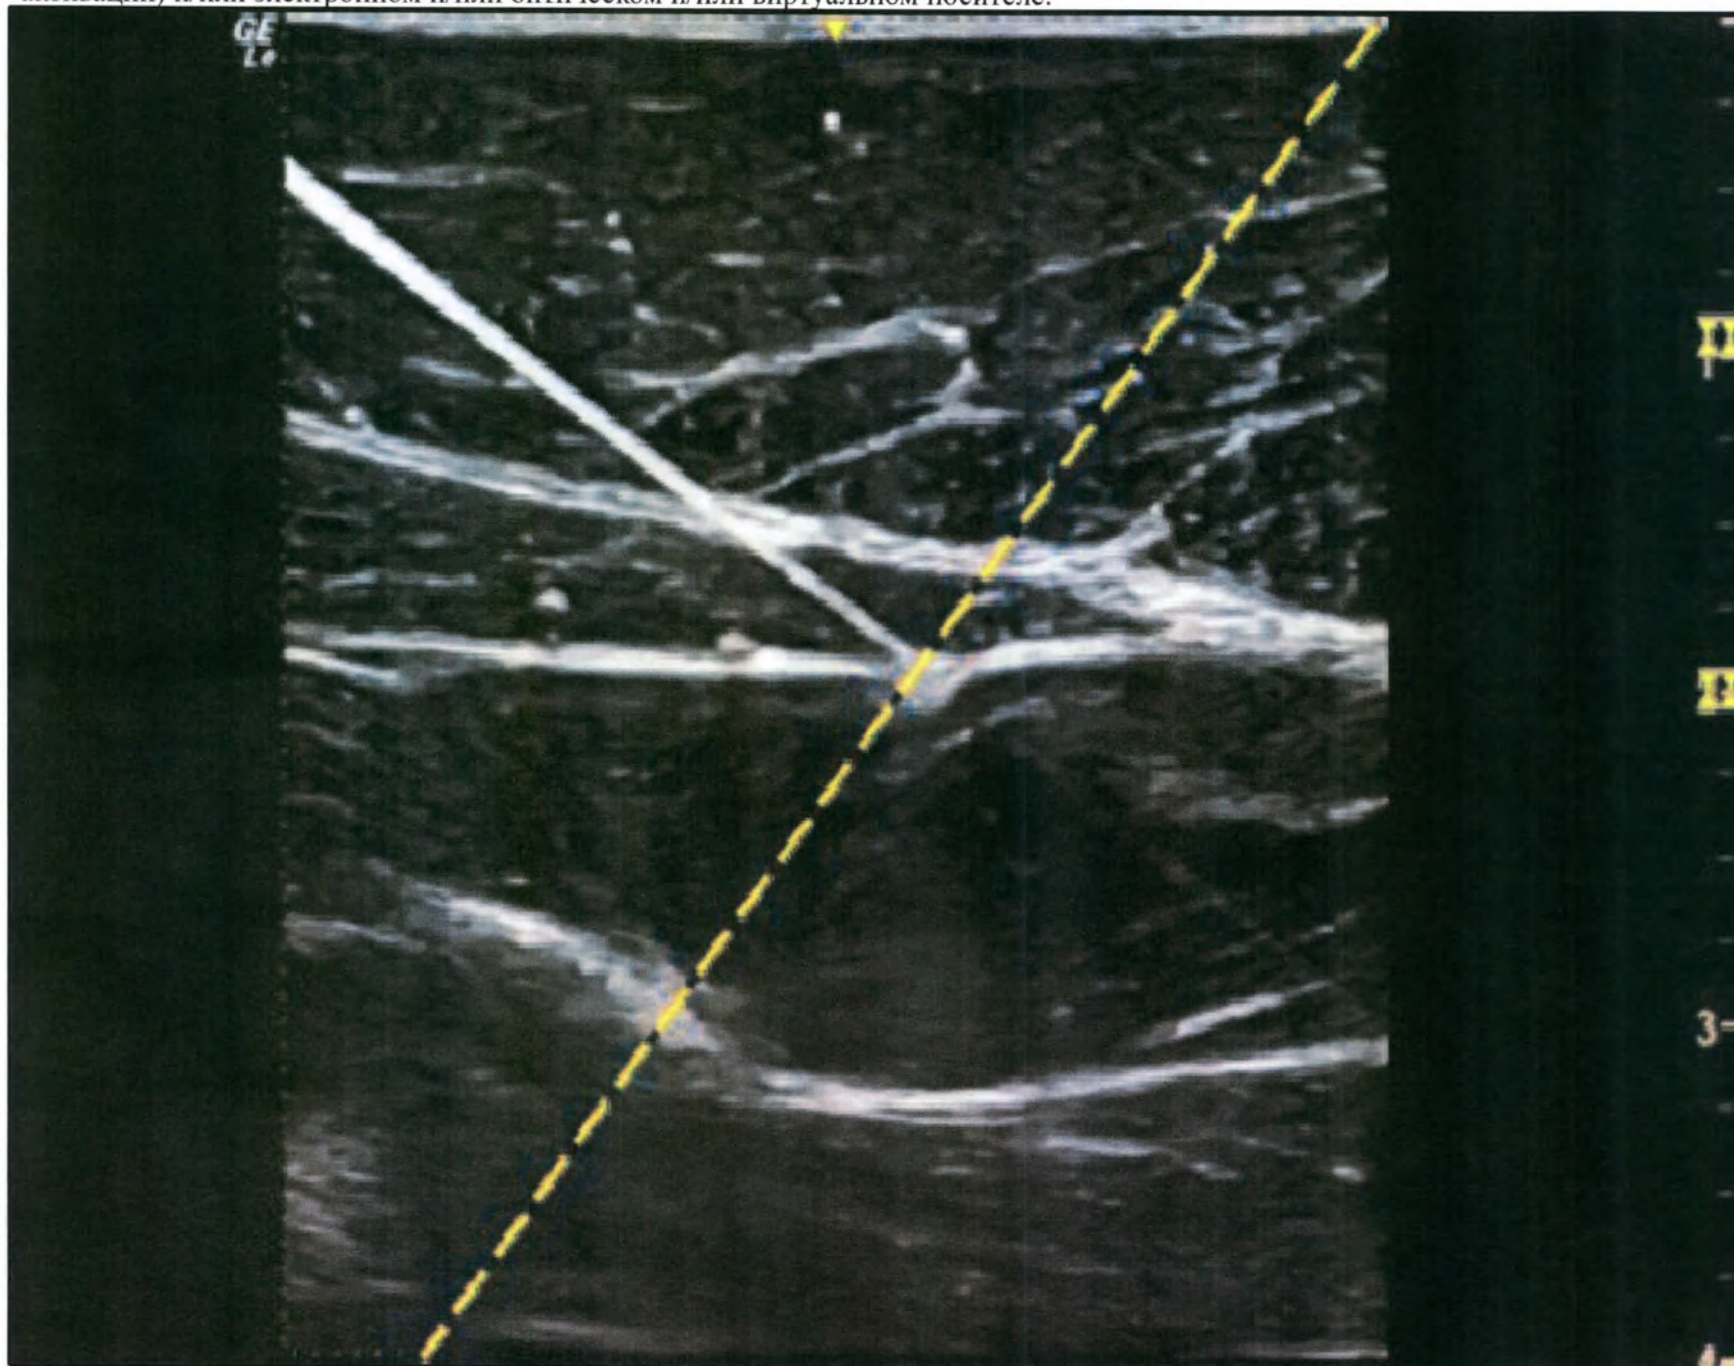

23. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме подавления зернистости – SRI на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




24. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме многолучевого составного сканирования – CrossBeam на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

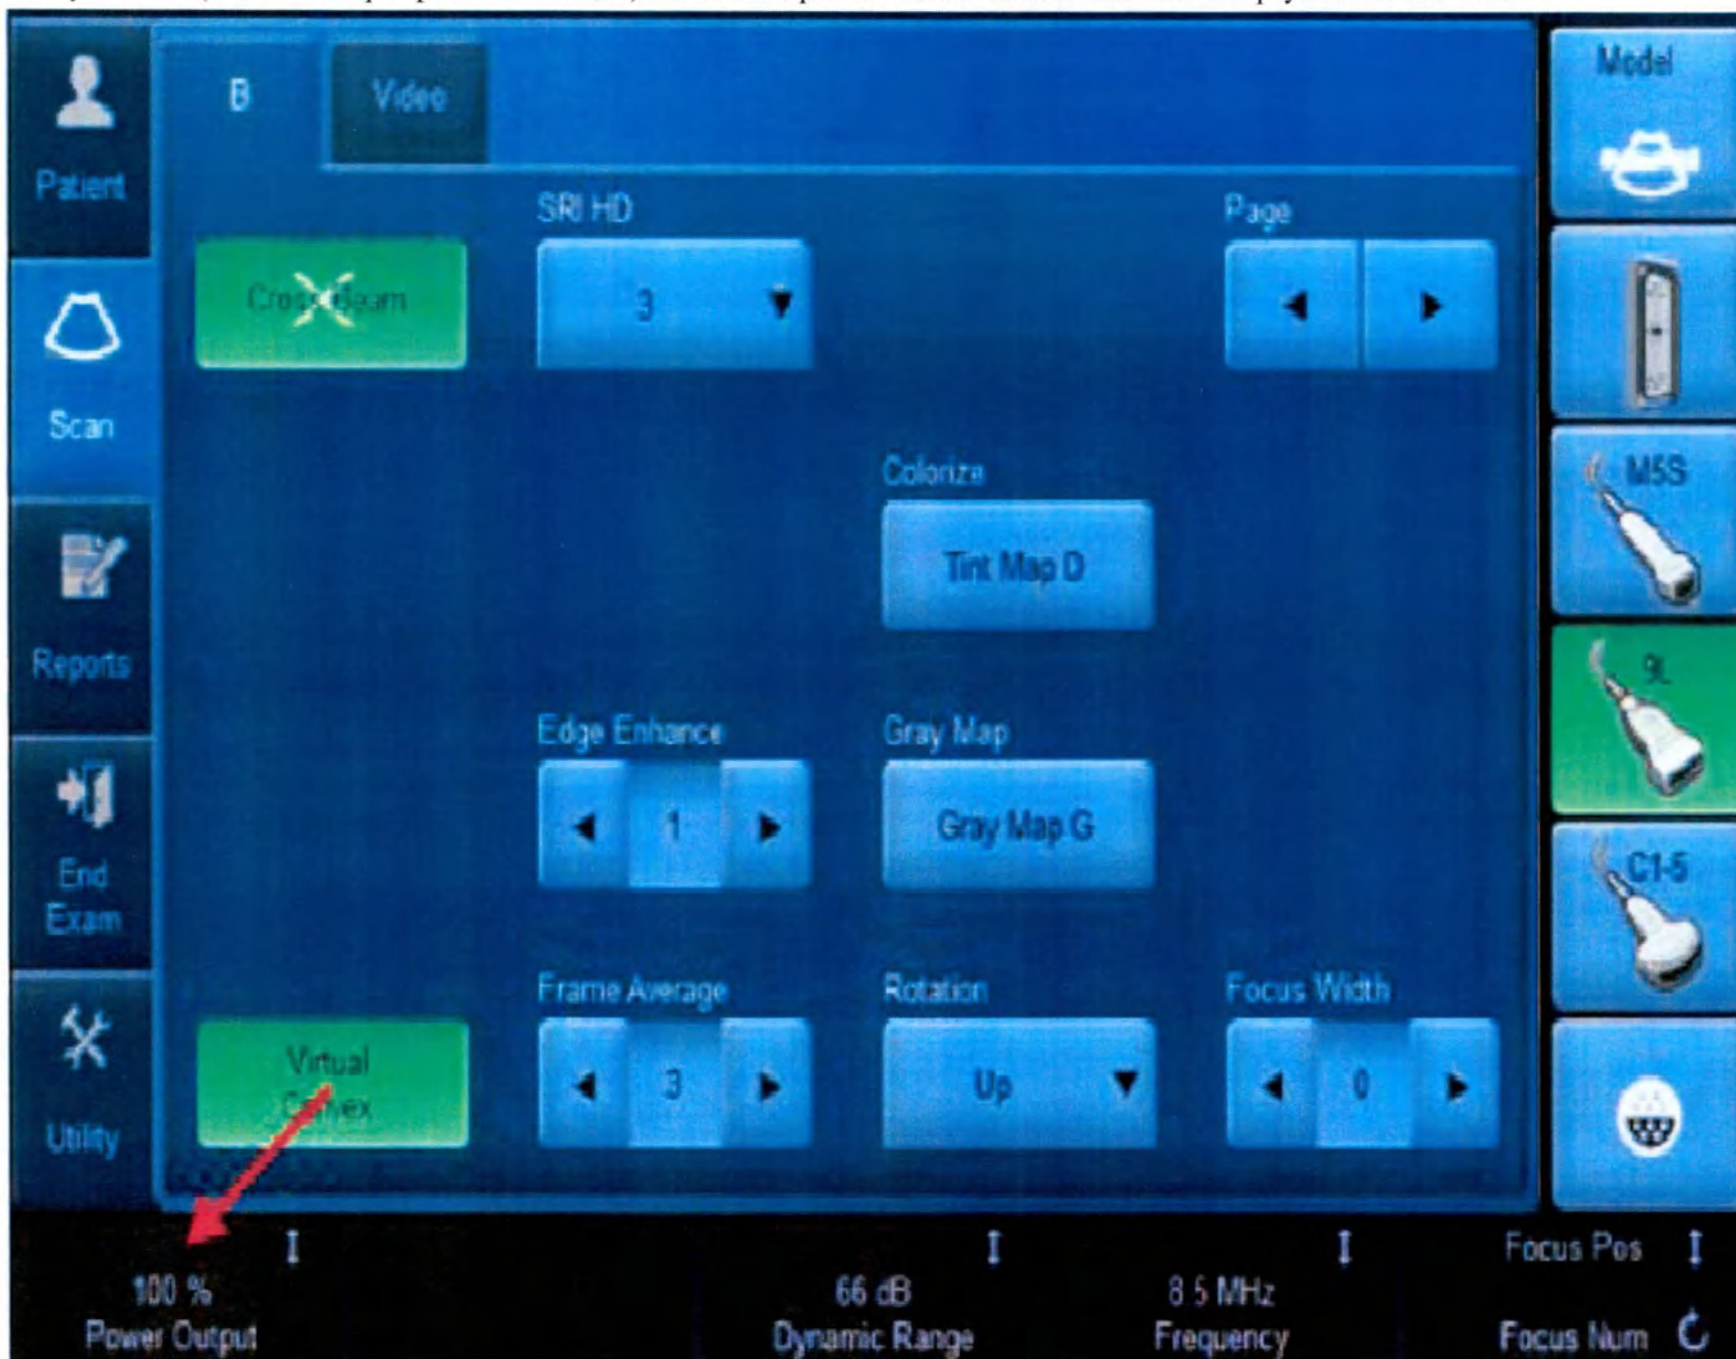

25. Устройство для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа - Auto IMT на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




26. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо - Stress Echo на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

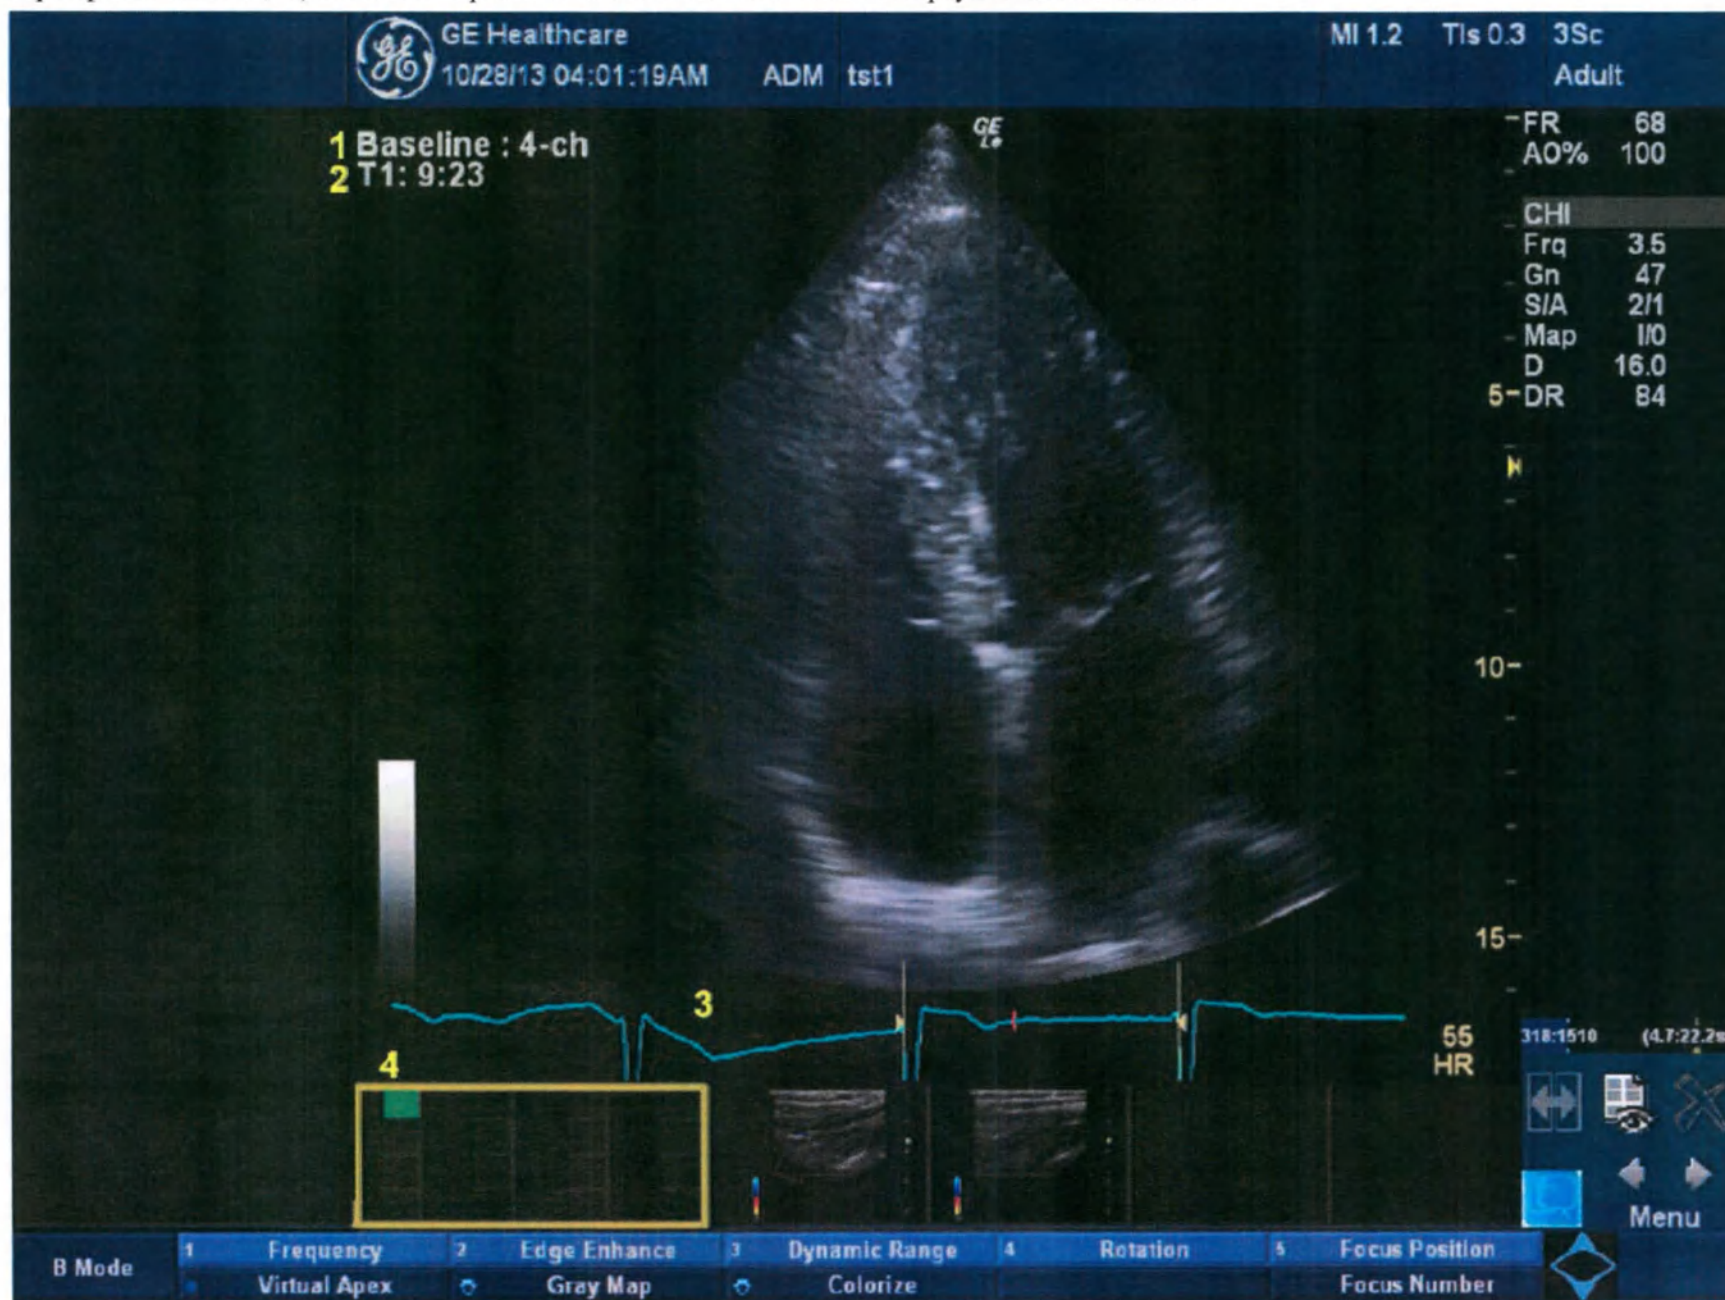


27. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме чреспищеводных исследований TEE Option на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.



28. Устройство для обучения пользователя - eSmart Trainer на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

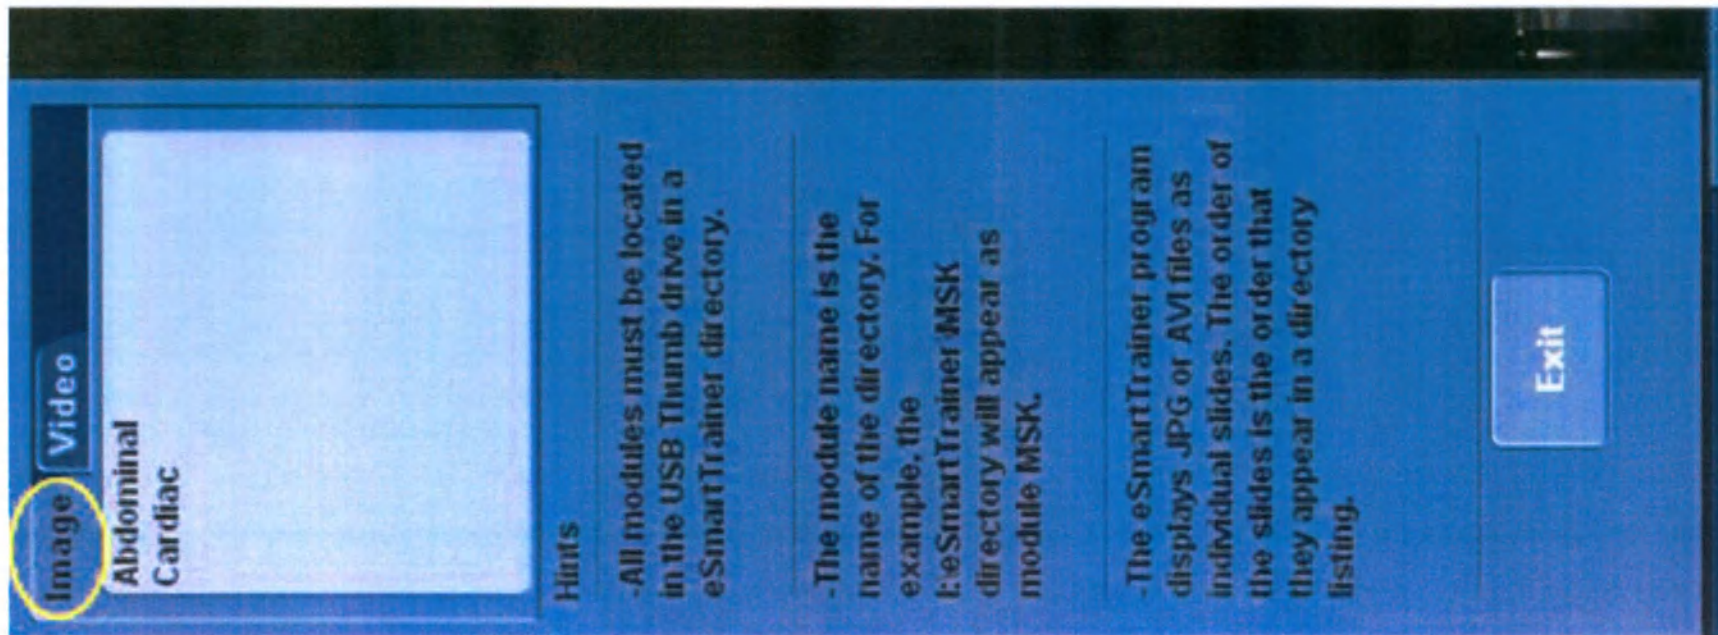


28. Устройство для обучения пользователя - eSmart Trainer на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

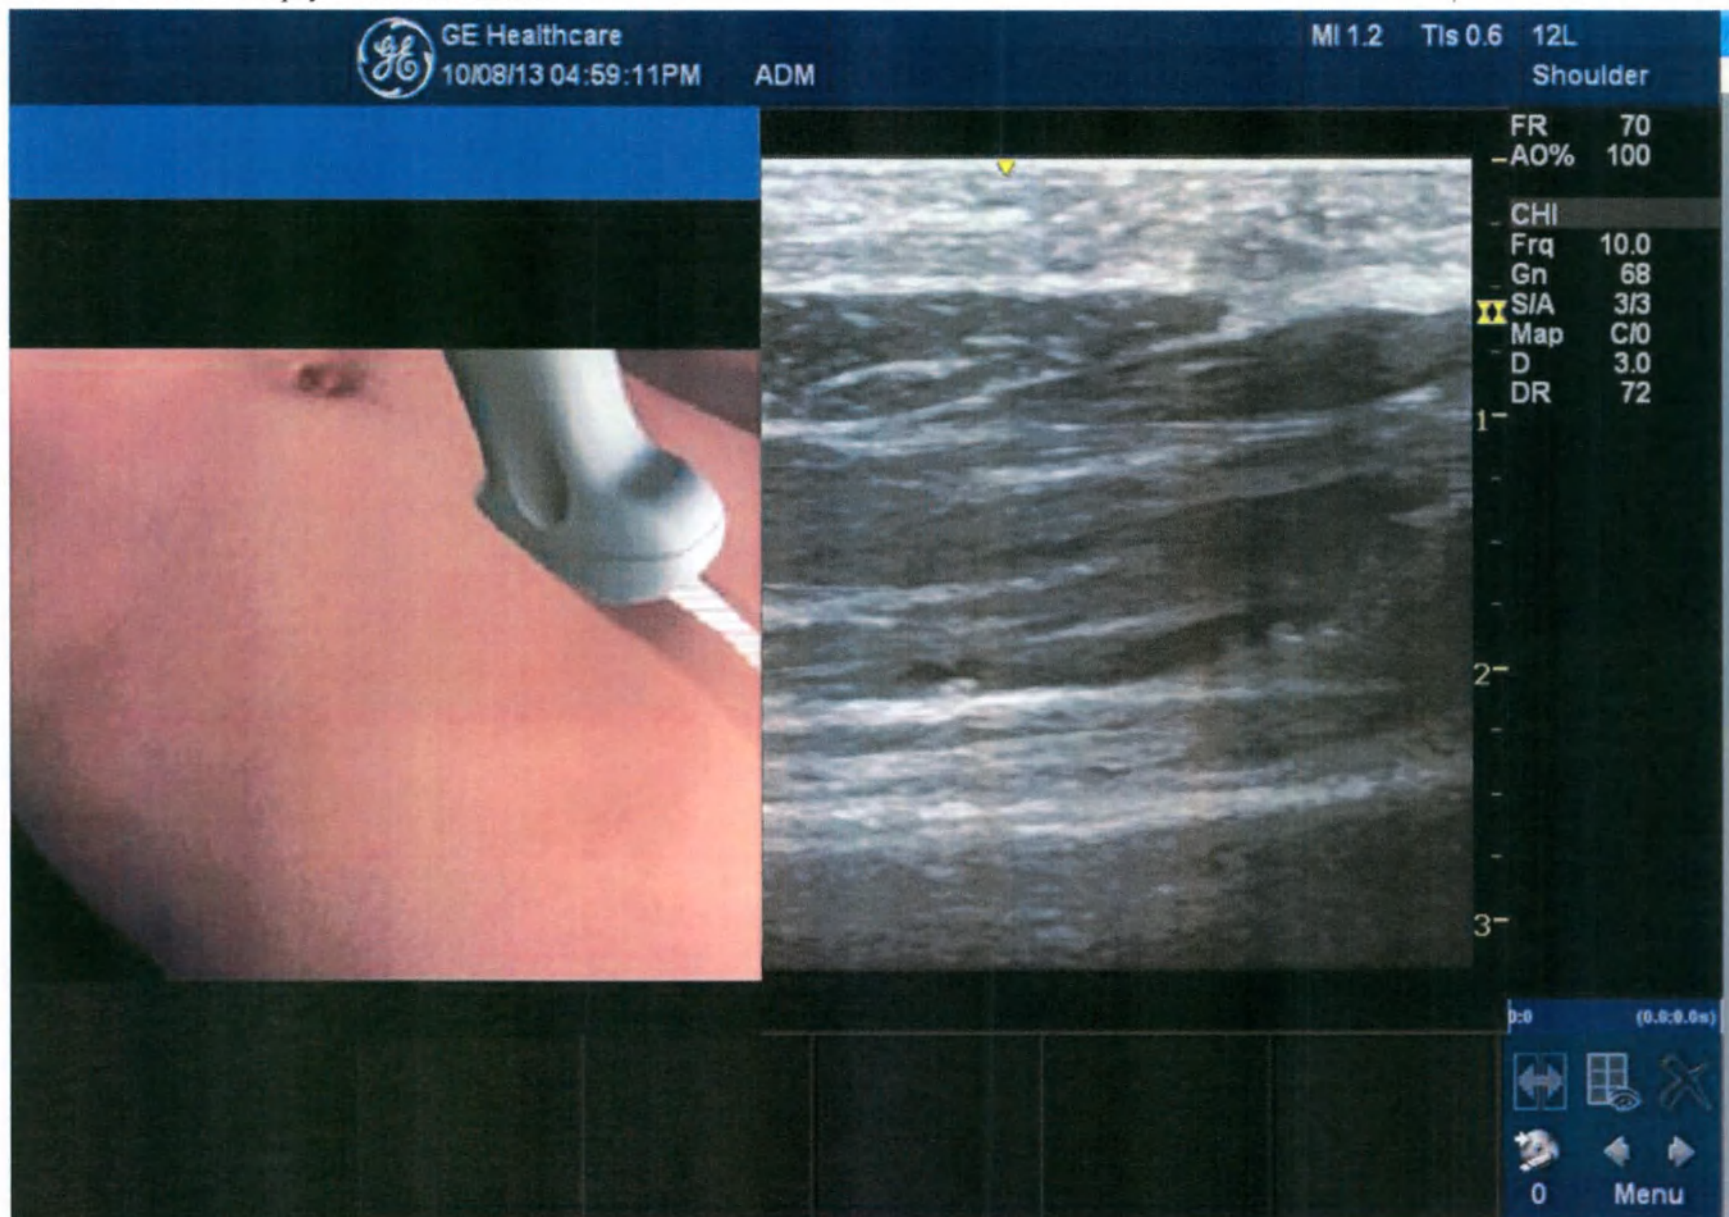

29. Устройство, обеспечивающее возможность передачи данных – DICOM на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.



30. Устройство для беспроводной передачи данных в формате DICOM на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе.

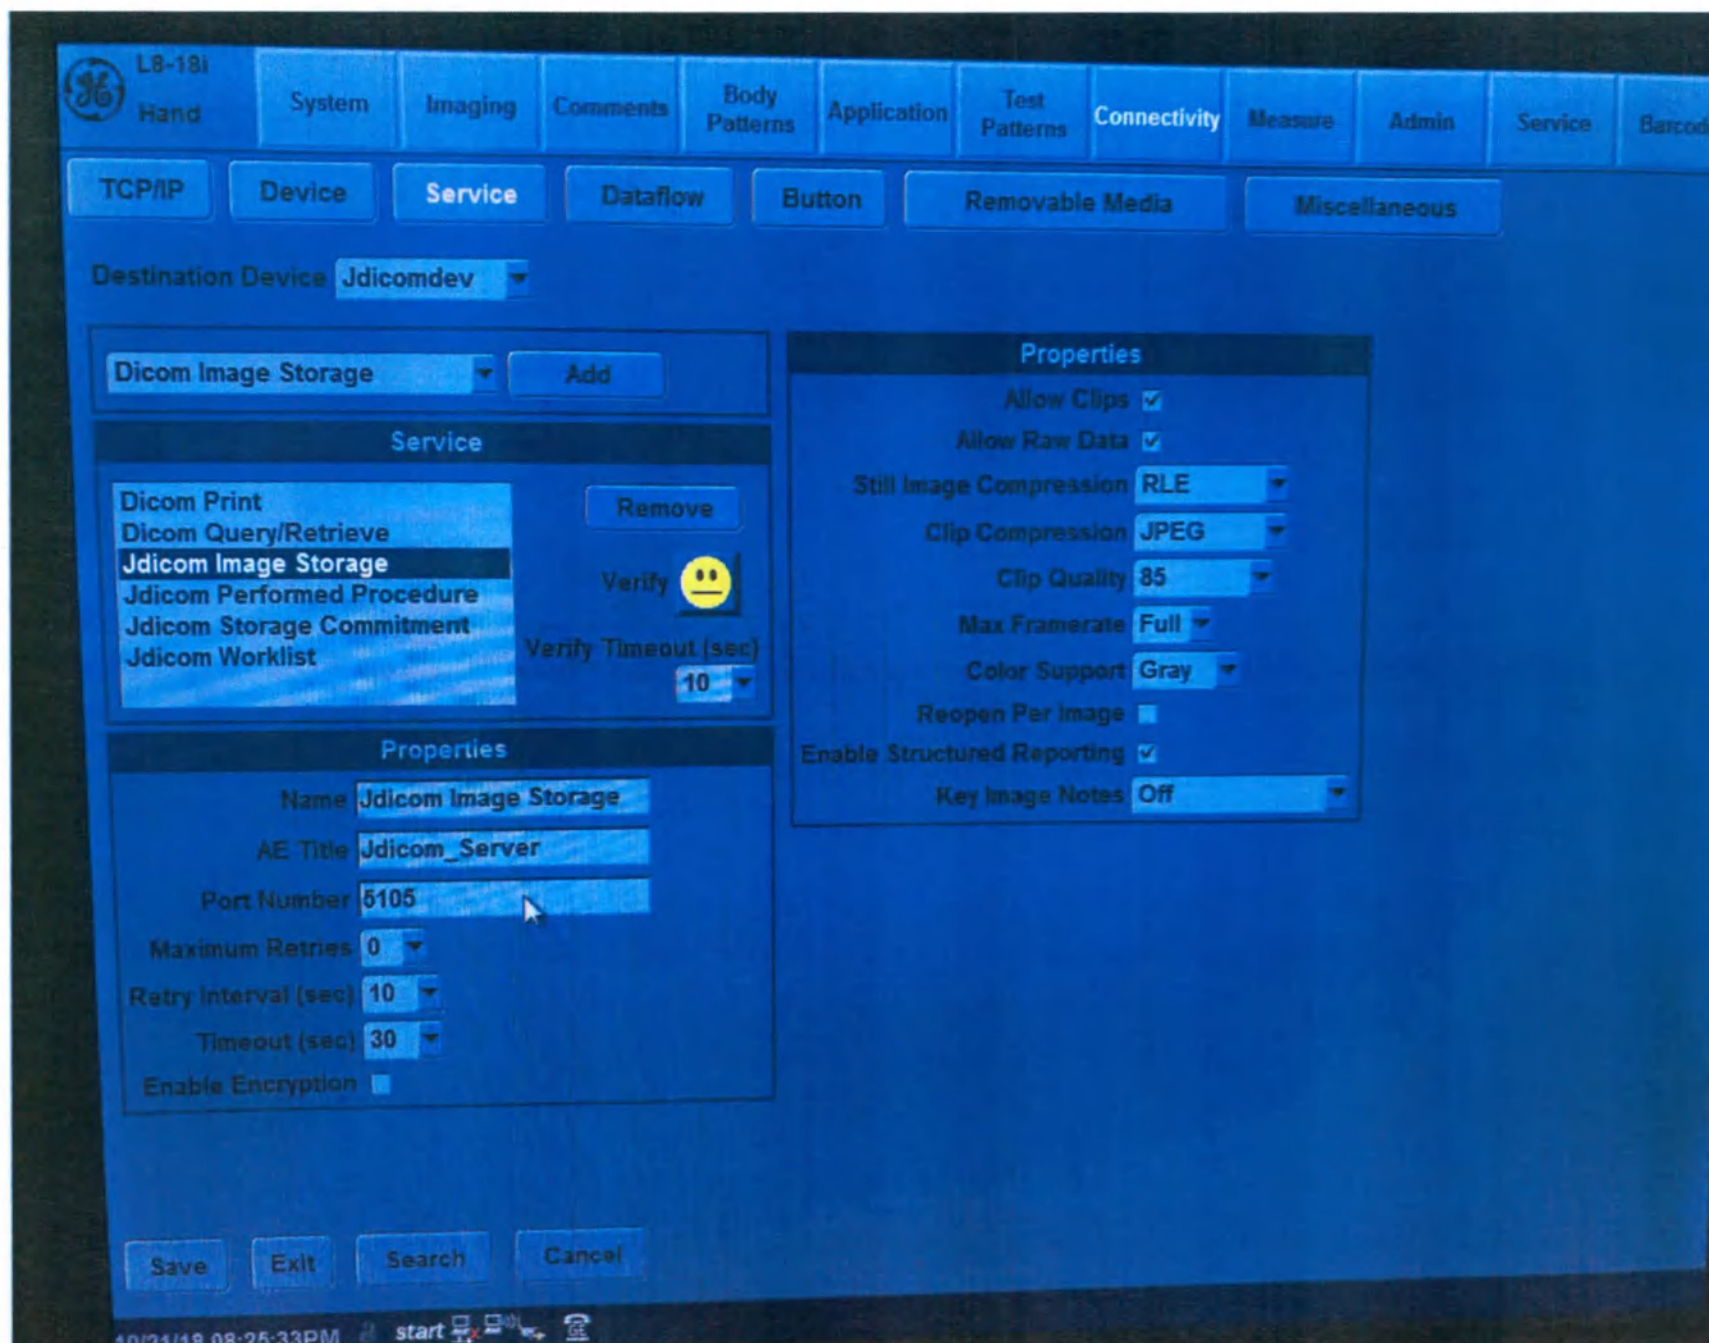

31. Устройство, обеспечивающее возможность беспроводной передачи данных

The screenshot displays the configuration interface of a GE LB-18i handheld ultrasound system. The top navigation bar includes tabs for System, Imaging, Comments, Body Patterns, Application, Test Patterns, Connectivity, Measure, Admin, Service, and Barcode. The 'Connectivity' tab is selected, showing sub-tabs for TCP/IP, Device, Service, Dataflow, Button, Removable Media, and Miscellaneous. The 'TCP/IP' sub-tab is active, displaying the 'Computer Name' as 'LOGIQE'. The 'IP settings' section includes a checked 'Enable DHCP' box, and fields for 'IP-Address', 'Subnet Mask', and 'Default Gateway'. The 'Network Speed' is set to 'Auto Detect'. The 'Connectivity Maintenance' section contains a 'Reset To Factory Default' button. A warning message states: 'Restart the system to activate any changes saved from this page!'. The 'Wireless Network' configuration section shows the following settings:

Wireless Network	
Configuration	
IP-Address	3.35.158.130
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	3.35.158.254

At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Exit', 'Search', and 'Cancel'. The system status bar at the very bottom shows the date and time '10/21/18 08:24:10PM' and the word 'start'.


32. Устройство для записи ультразвуковых изображений на CD и DVD диски - DVD/CD Drive LiteON




33. Мобильная тележка для перемещения системы ультразвуковой диагностической




34. Дополнительные ящики для тележки

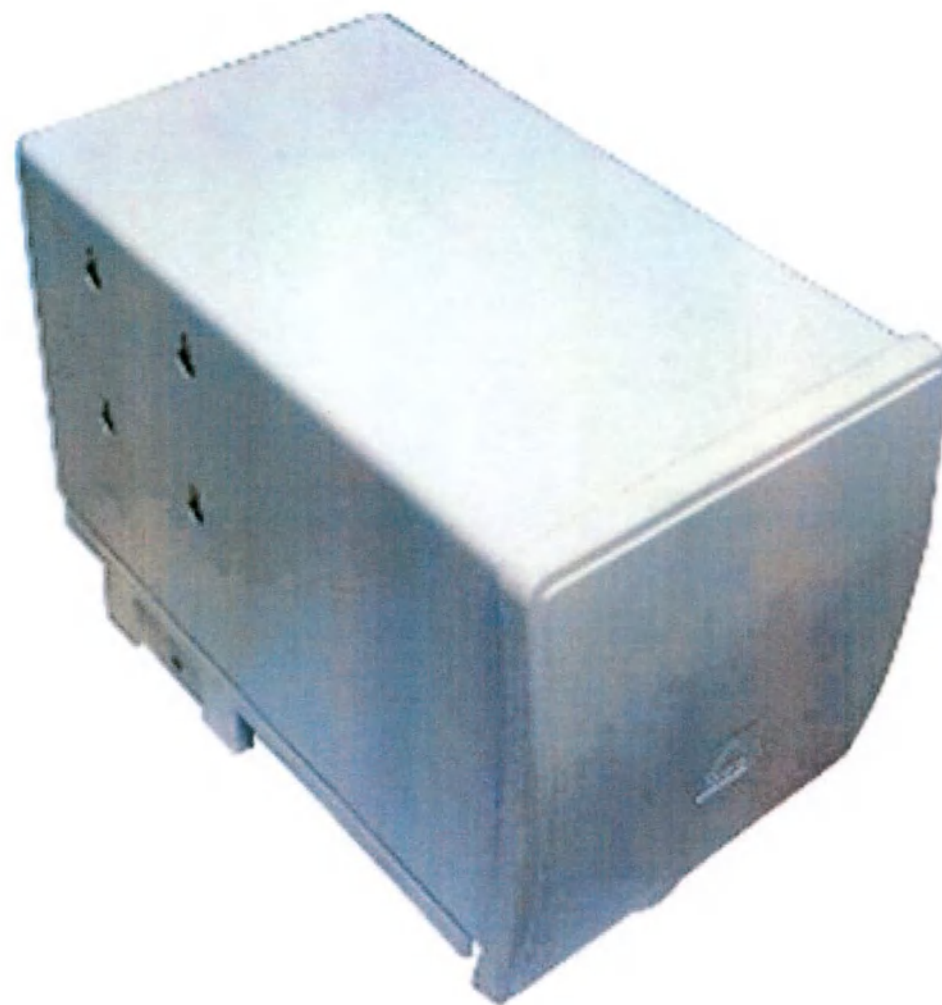

35. Док-станция для ультразвуковой системы мобильная с возможностью подключения к сети

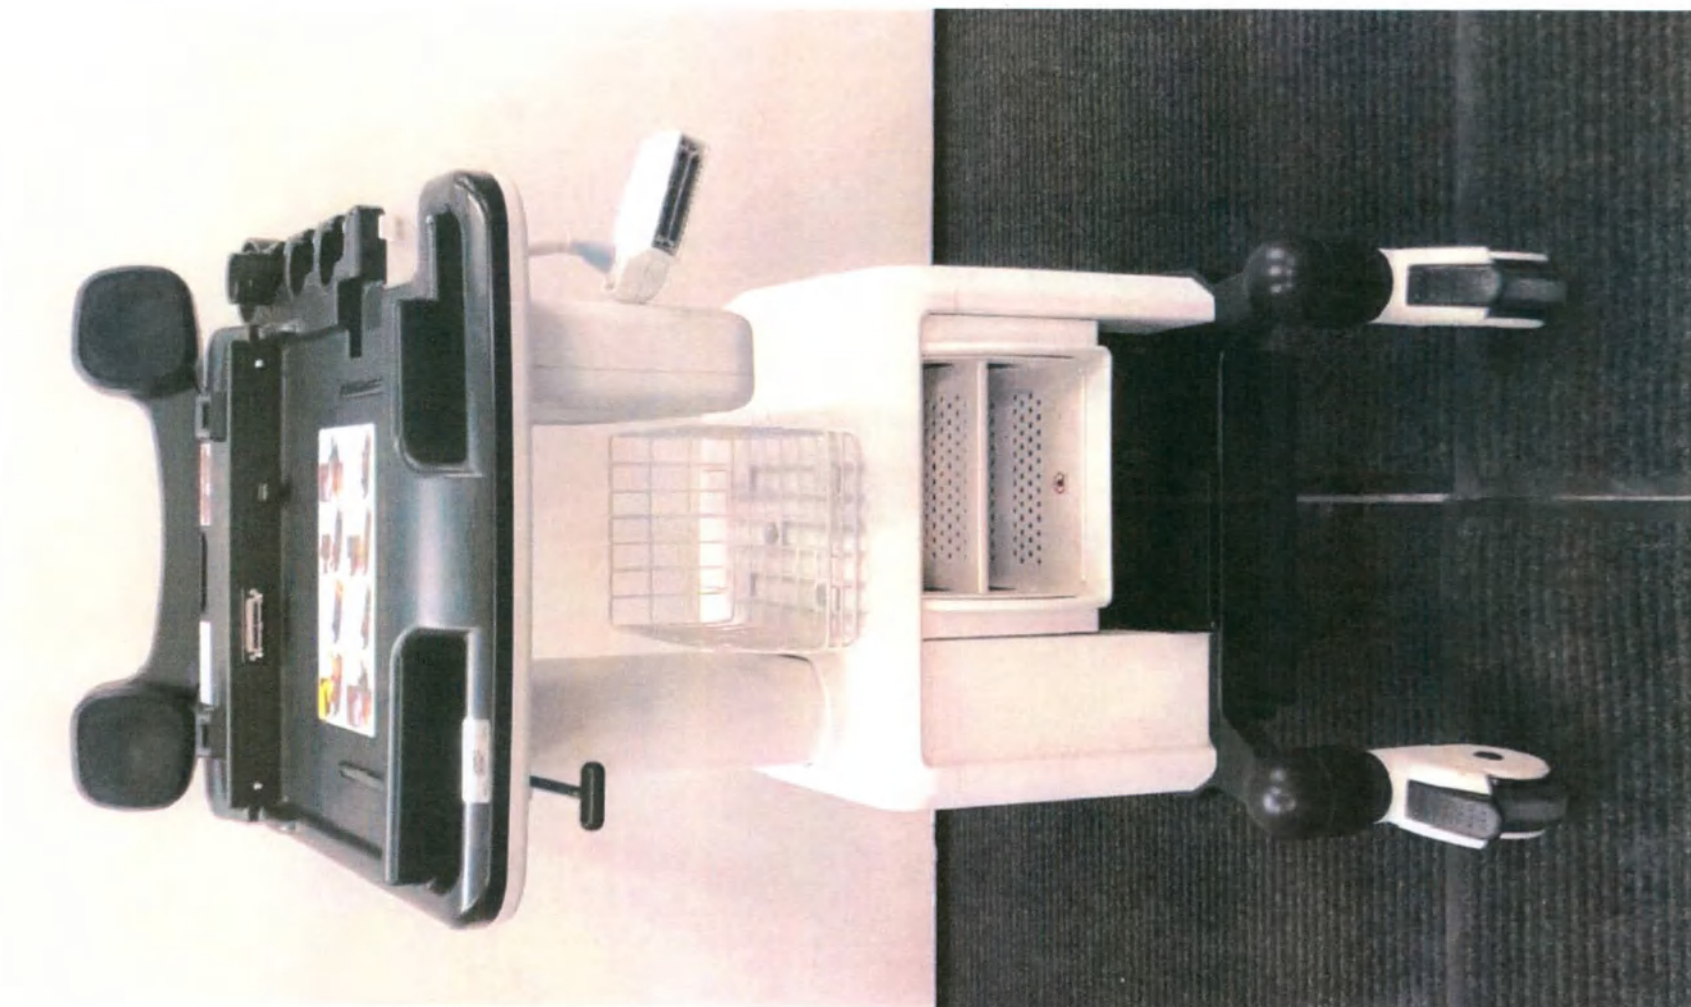


36. Полки для принтера для док-станции

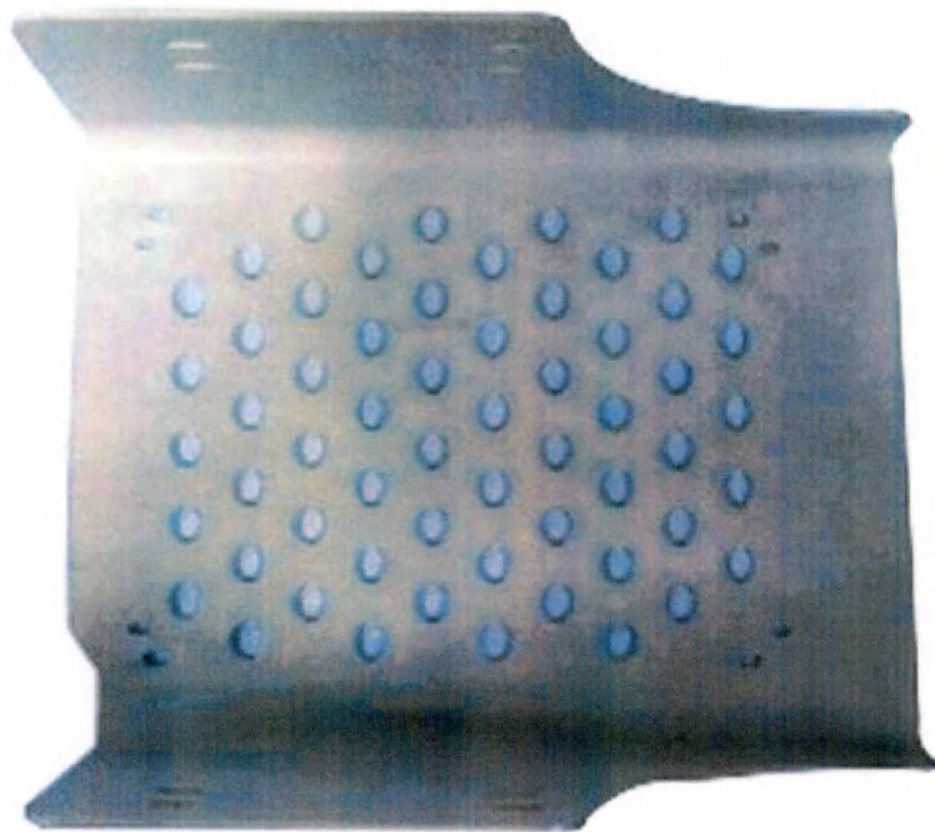

37. Адаптер 3-х портовый для подключения датчиков



38. Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов с комплектом кабелей

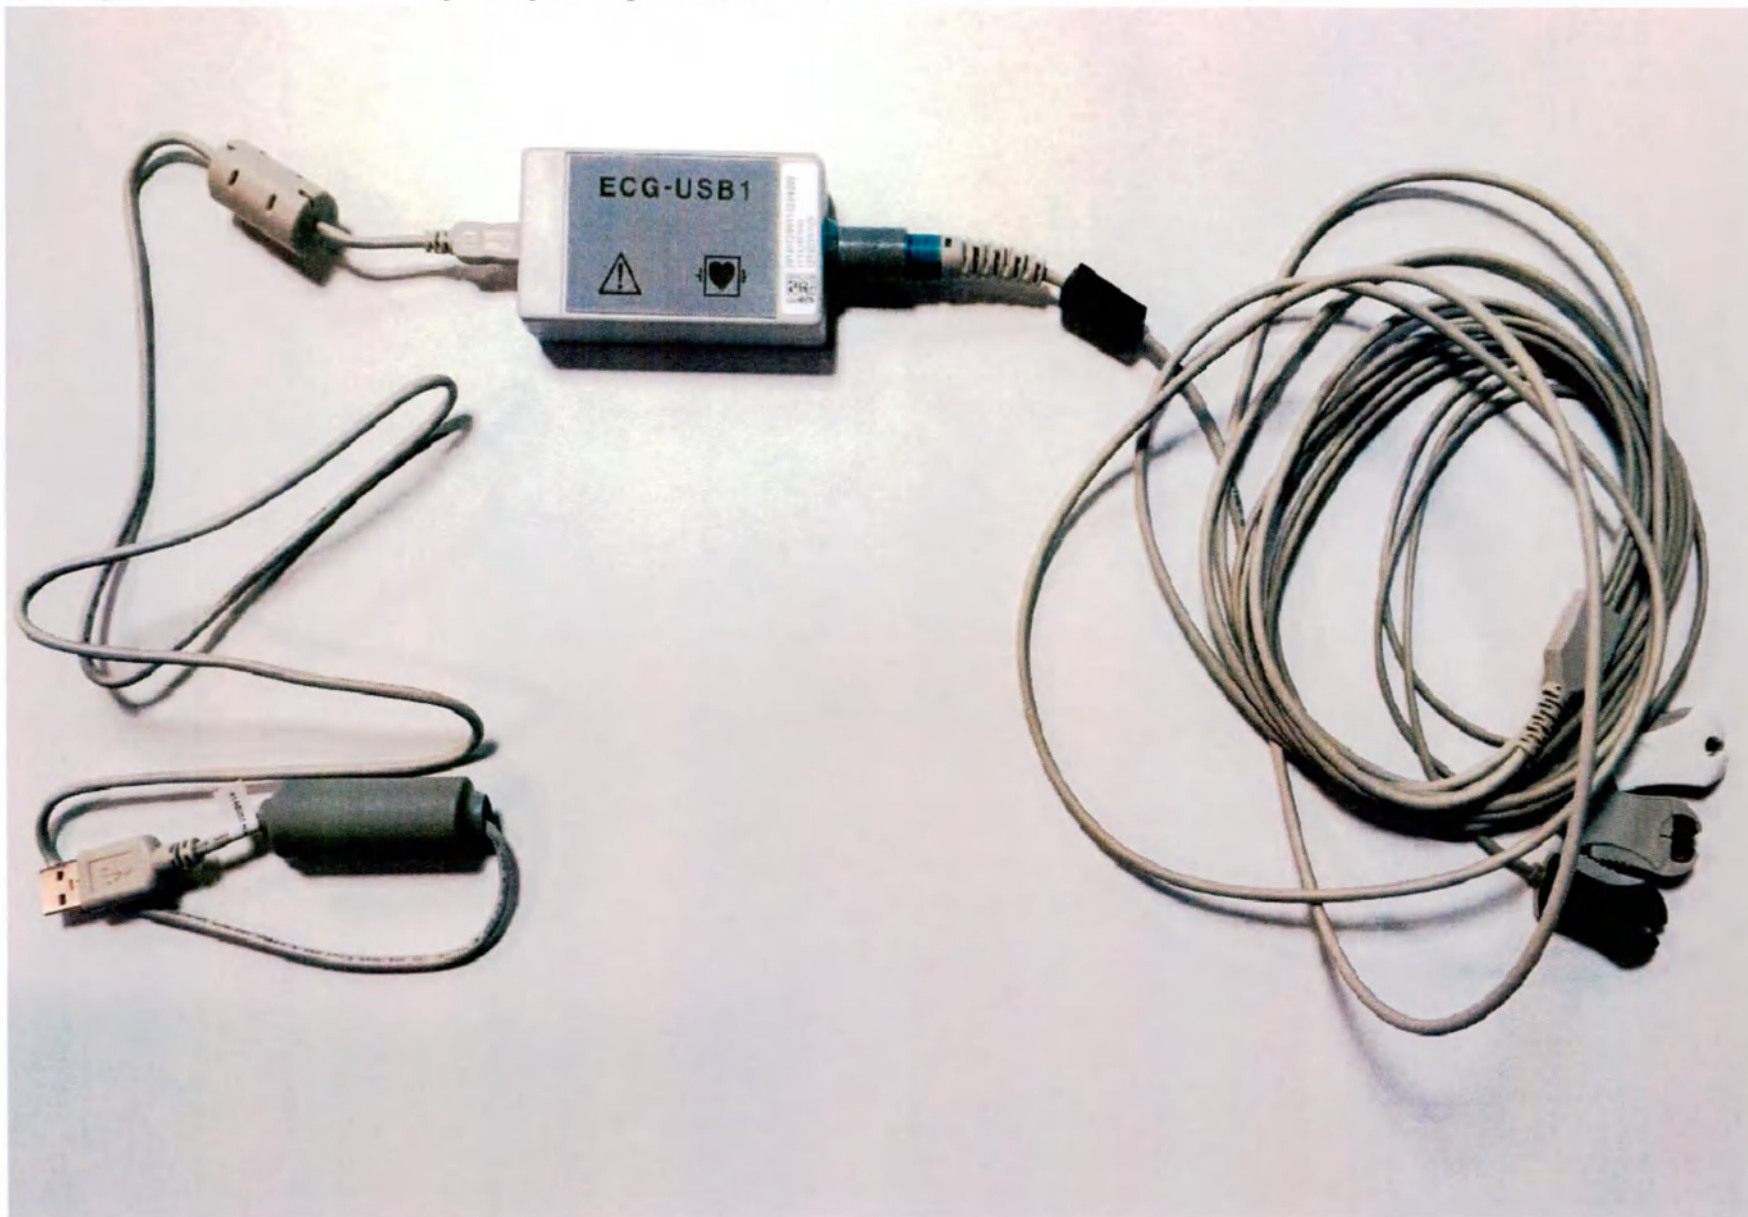

39. Сумка для транспортировки для системы ультразвуковой диагностической



40. Ножной переключатель - Footswitch.



41. Аккумуляторная батарея




42. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи



43. Защитный чехол для системы ультразвуковой диагностической




43. Защитный чехол для системы ультразвуковой диагностической

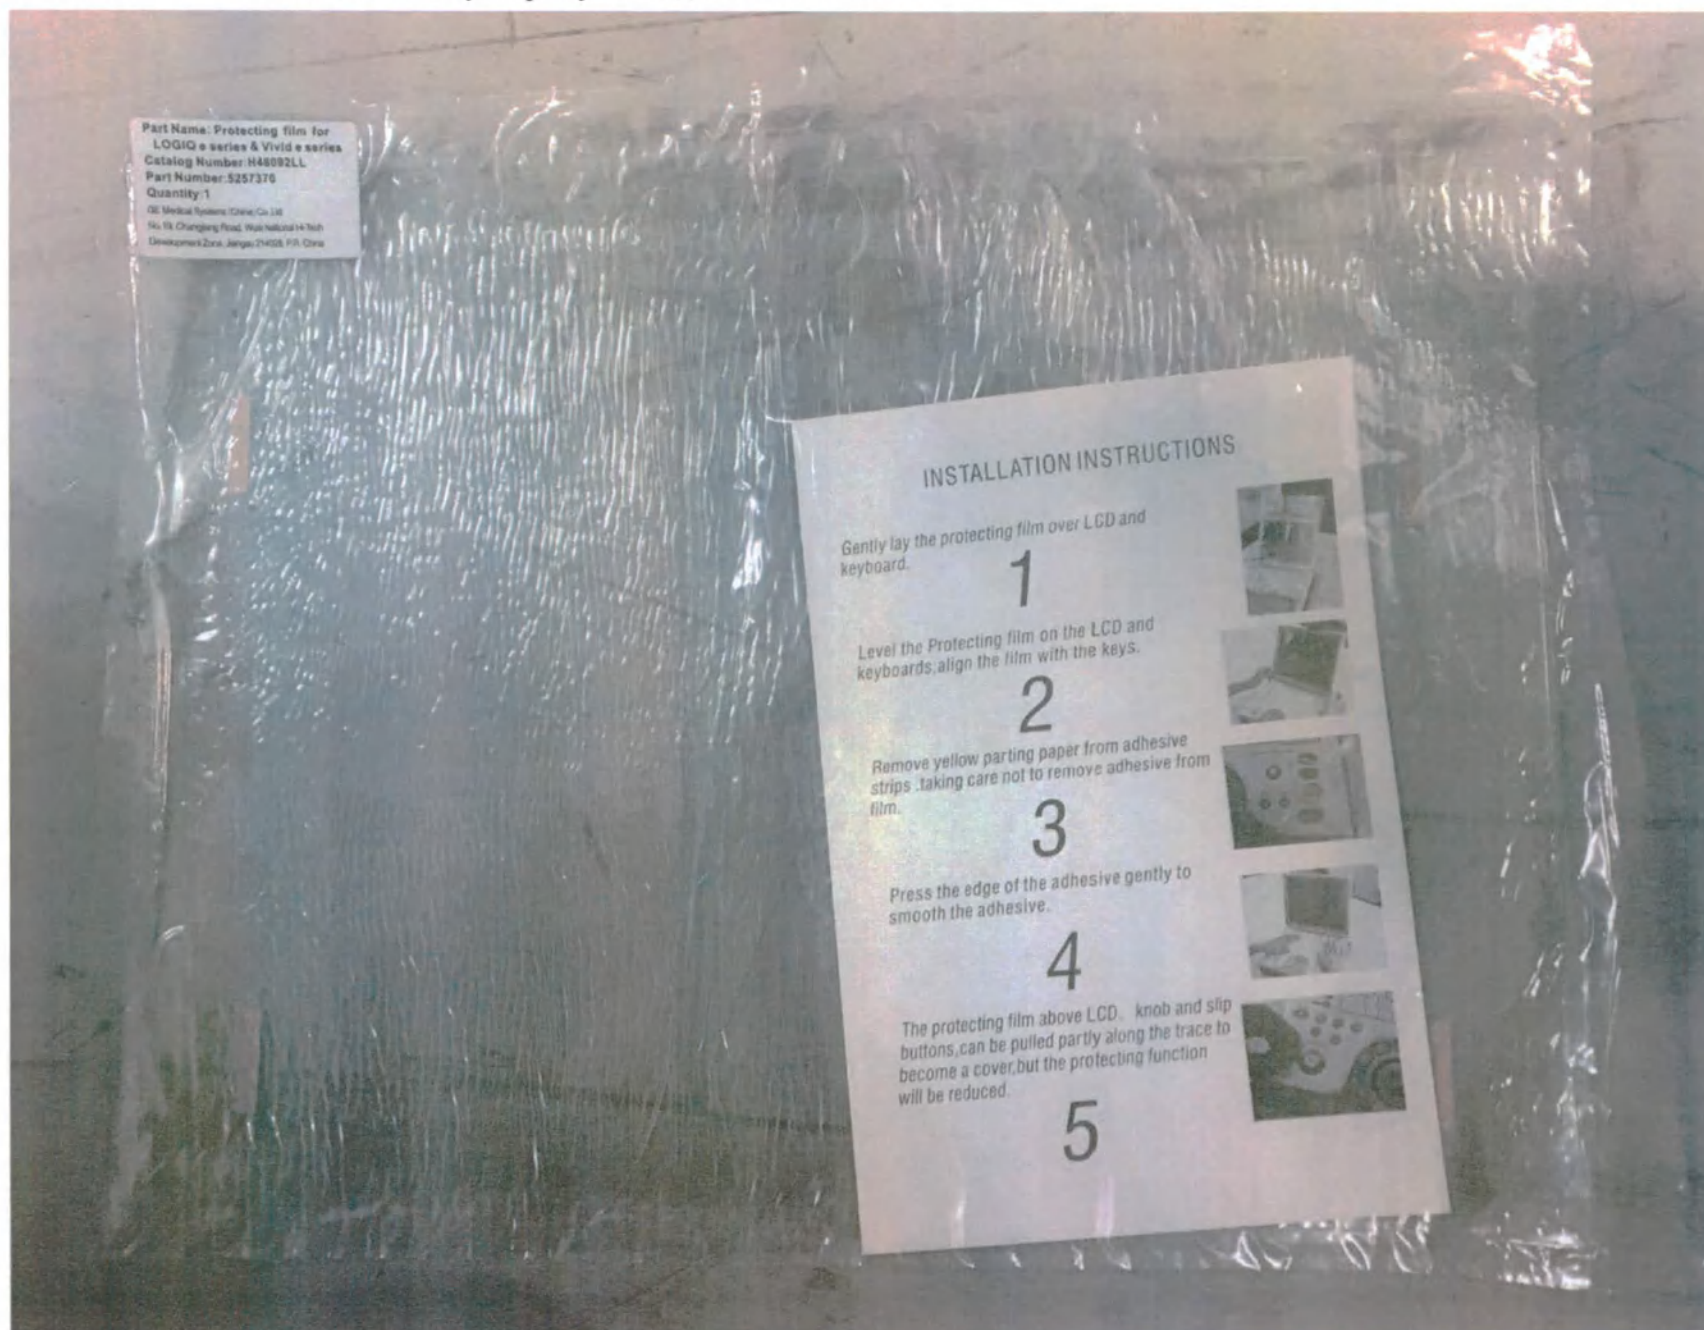

44. Устройство, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения SONY



45. Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения

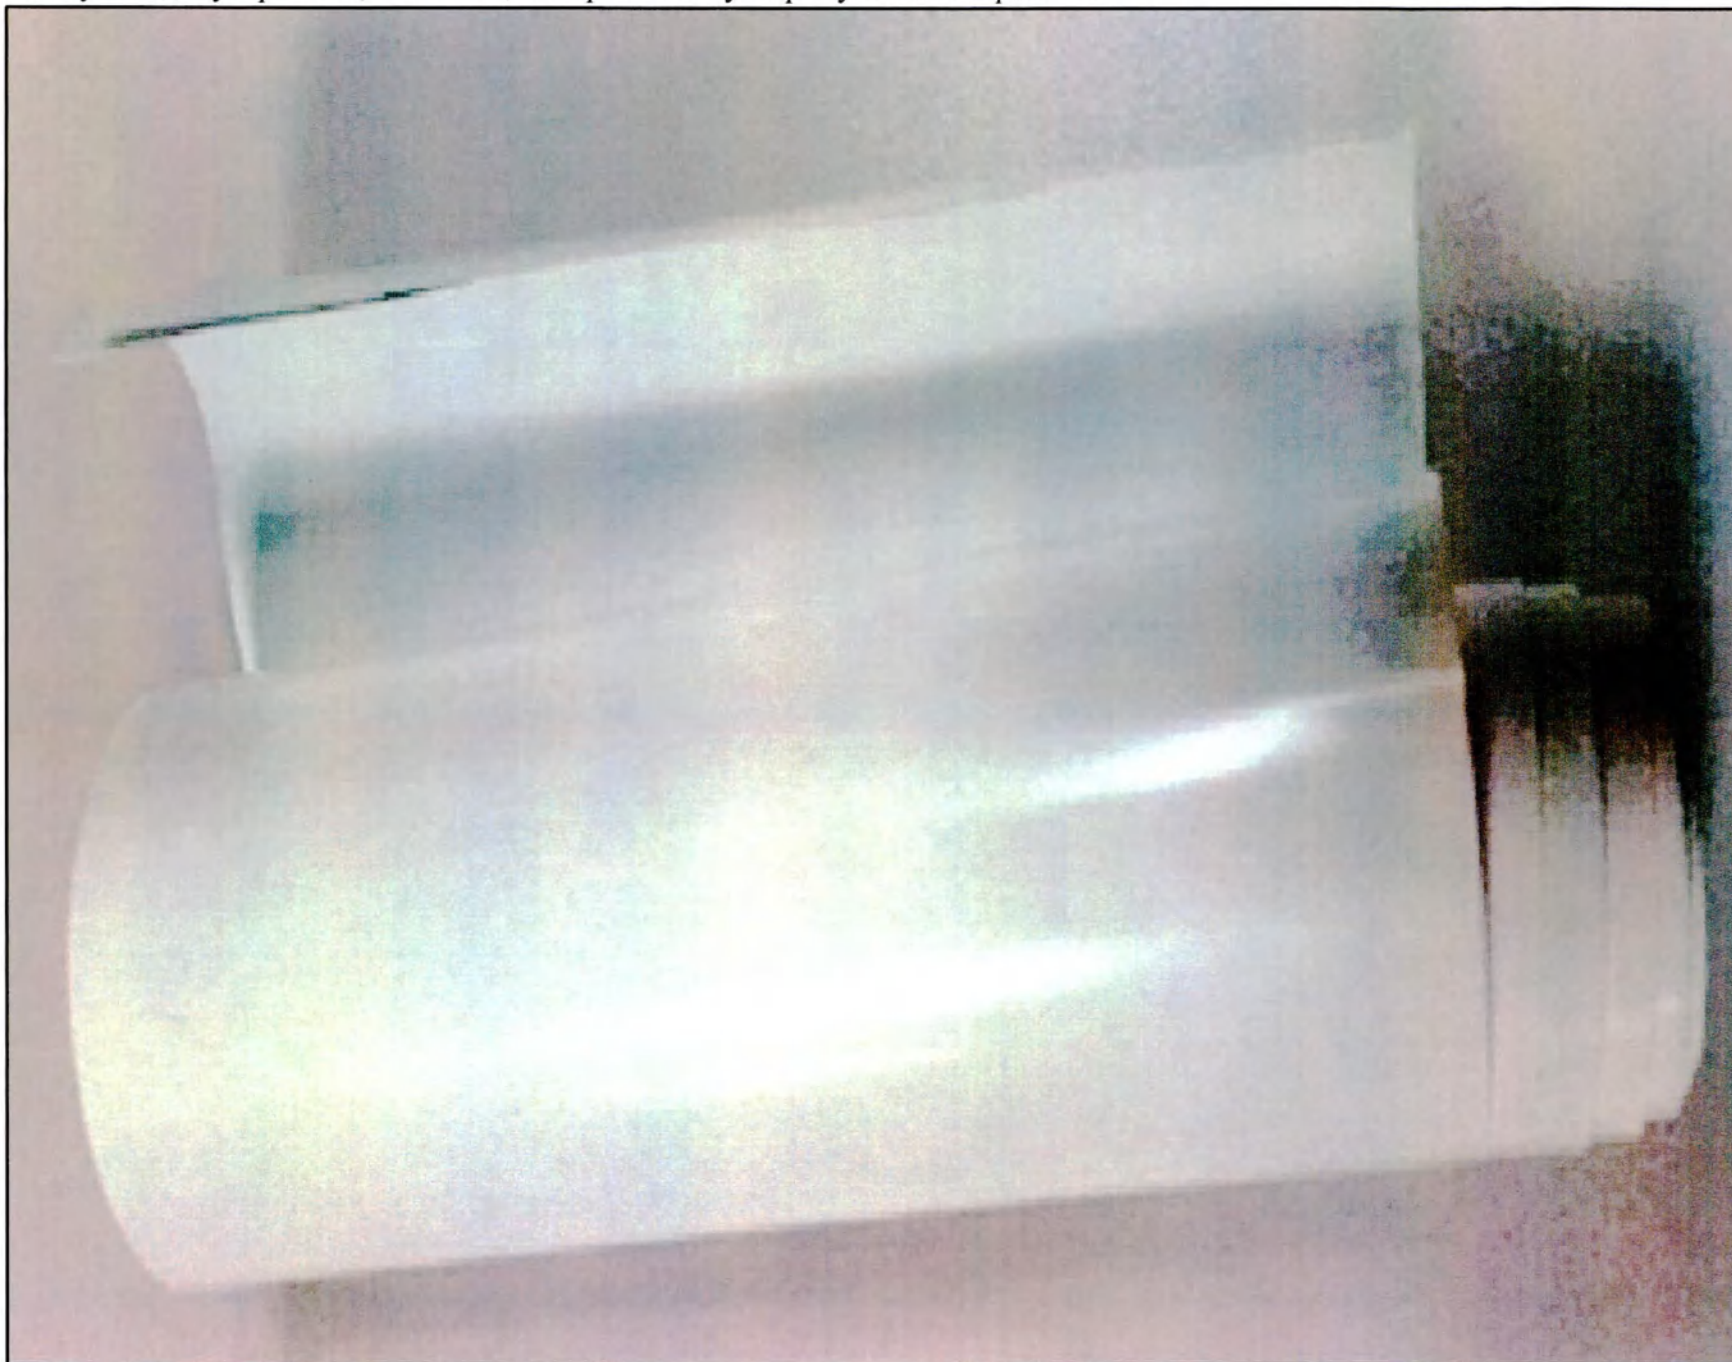


47. Кабель электропитания



48. Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения SONY



49. Крепление для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения

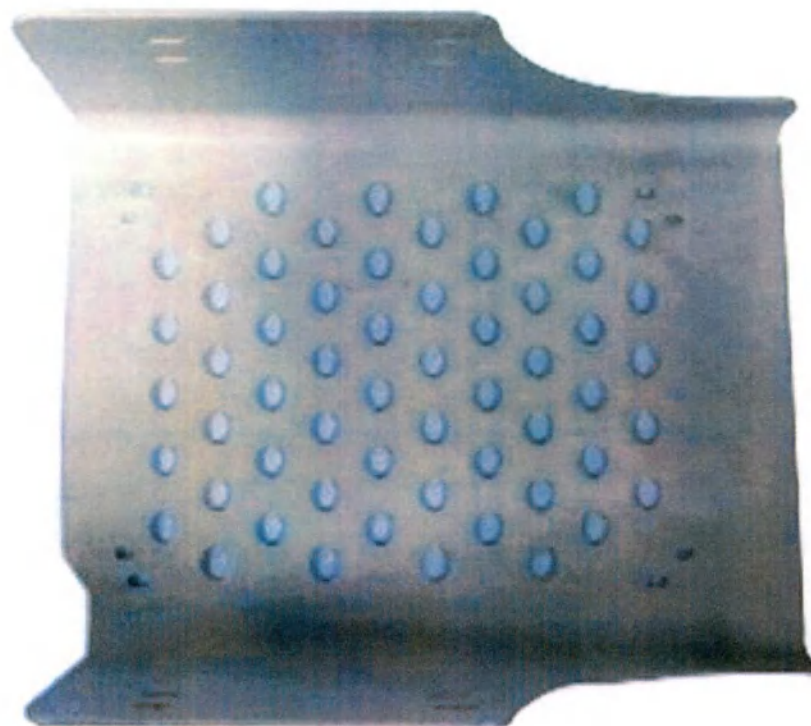

50. Гель ультразвуковой в стандартной упаковке Aquasonic



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


75

листа(ов)



Макеты маркировки
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e
с принадлежностями

Директор департамента Регистрации
и Сертификации, Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А. П. Харитоновна

«25» 2024 г.



1) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ

Датчик конвексный C1-5-RS, Датчик микроконвексный 8C-RS, Датчик микроконвексный внутриполостной E8C-RS, Датчик линейный 9L-RS, Датчик линейный 12L-RS, Датчик линейный широкополосный L10-22-RS, Датчик линейный L8-18i-RS, Датчик линейный L4-12t-RS, Датчик линейный матричный ML6-15-RS, Датчик секторный фазированный широкополосный 3Sc-RS, Датчик секторный фазированный широкополосный 6S-RS, Датчик чреспищеводный фазированный 6Tc-RS

Макет маркировки:




- 1. Логотип компании GE
- 2. Модель датчика (название)
- 3. Символ UDI (Уникальный идентификатор устройства) и матричный штрихкод
- 4. Удобочитаемый уникальный идентификатор устройства
- 5. Тип рабочей части BF/CF
- 6. Предупреждение о необходимости изучить руководство
- 7. Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования

- 8. Символ RoHS (для Китая), указывающий на содержание опасных веществ
- 9. Знак CE и код органа сертификации
- 10. Номер по каталогу/номер модели
- 11. Серийный номер
- 12. Страна-изготовитель
- 13. Официальное название и юридический адрес производителя
- 14. Дата изготовления
- 15. Торговый индикатор продукта
- 16. Класс защиты IP

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Макет маркировки упаковки изделия:

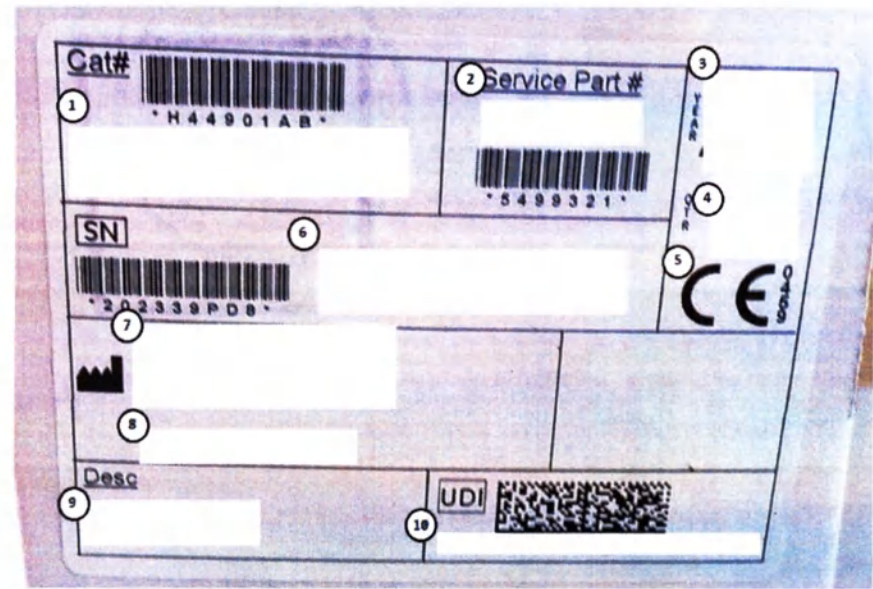

1	Номер по каталогу
2	Сервисный номер
3	Год изготовления

4	Квартал изготовления
5	Символ соответствия стандарту ЕС
6	Серийный номер
7	Изготовитель
8	Страна производства/сборки
9	Наименование изделия
10	Уникальный идентификационный номер

Загубник для чреспищеводного датчика Clip-on Biteguard, Загубник для чреспищеводного датчика Gastroguard
Макет маркировки упаковки изделия:

1 [] 2 [] 17 CE

REF 3 [] P/N 4 [] Cat# 5 []

MD 7 [] 8 []

Exp. Date: 9 [] QTY: 10 []

Storage: 11 [] 18 [] 12 []

13 [] Date of Manufacture: []

UDI-DI: 14 []

LOT 15 []

16 []

(422)5962596226060 (11)210504

1	Логотип изготовителя
2	Наименование
3	Каталожный номер
4	Парт номер
5	CAT номер
7	Предупреждение о необходимости изучить руководство
8	Не стерильно
9	Использовать до
10	Количество
11	Условия хранения
12	Дата изготовления
13	Температурный диапазон
14	Уникальный идентификационный номер
15	Серийный номер
16	Наименование, адрес производителя
17	Знак CE
18	Не допускать воздействия солнечного света

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Адаптер для проведения биопсий для конвексных датчиков C1-5, Адаптер для проведения биопсии для датчиков линейных матричных ML6-15, Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 9L, Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 11L/12L, Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L, Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L-RS, Адаптер для проведения биопсий для секторных фазированных датчиков 3Sc

Адаптер для проведения биопсий для микроконвексных внутриматричных датчиков E8C

Макет маркировки упаковки изделия:

Blank template for product labeling. It includes numbered fields for: 1. Manufacturer logo, 2. Catalog number, 3. Quantity, 4. Lot code, 5. Name, 6. Composition, 7. Sterilization requirement (R ONLY), 8. Name in other languages, 9. Application diagram, 10. UDI and matrix barcode, 11. Temperature range, 12. CE mark and certification code, 13. Date of manufacture, 14. Use by, 15. Do not expose to sunlight, 16. Read instructions, 17. Manufacturer, 18. Barcode, 19. Drawing number, 20. Ethylene oxide sterilization, 21. Precautions, 22. Do not use if packaging is damaged.

Filled-in example of the product labeling template. It shows the same layout as the blank template but with sample data entered in the fields, including a date of manufacture (13), a use-by date (14), and a drawing number (19).

1 Логотип производителя

2 Номер по каталогу

3 Количество

4 Код партии

5 Наименование

6 Состав

7 Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача (Только для США)

8 Название на других языках

9 Схема применения

10 UDI (Уникальный идентификатор устройства) и матричный штрихкод

11 Температурный диапазон

12 Знак CE и код органа сертификации

13 Дата изготовления

14 Использовать до

15 Не допускать воздействия солнечного света

16 Обратитесь к инструкции по применению

17 Производитель

18 Штрих-код

19 Номер чертежа

20 Стерилизация оксидом этилена

21 Предостережения

22 Не использовать при повреждении упаковки

23 Запрет на повторное применение


24 Другие применимые символы, надписи

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Ножной переключатель - Footswitch

Макет маркировки изделия:

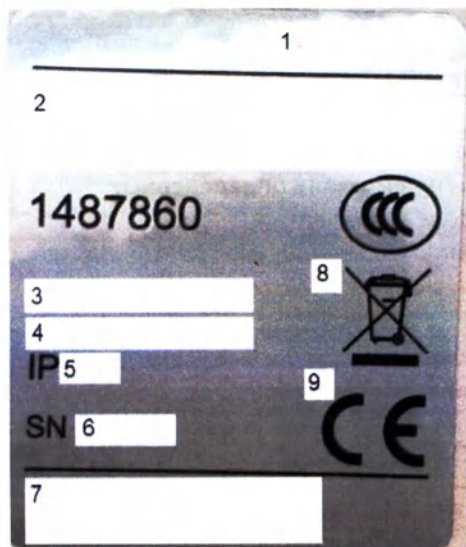


1	Логотип производителя
2	Модель
3	Параметры электропитания
4	Стандарт соответствия
5	Степень защиты от проникновения воды или твердых частиц
6	Серийный номер
7	Наименование, адрес производителя
8	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
9	Символы соответствия зарубежным стандартам (не применимо для РФ)

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

Адаптер металлический для проведения биопсий для микроконвексных внутрисполостных датчиков E8C


Макет маркировки упаковки изделия:

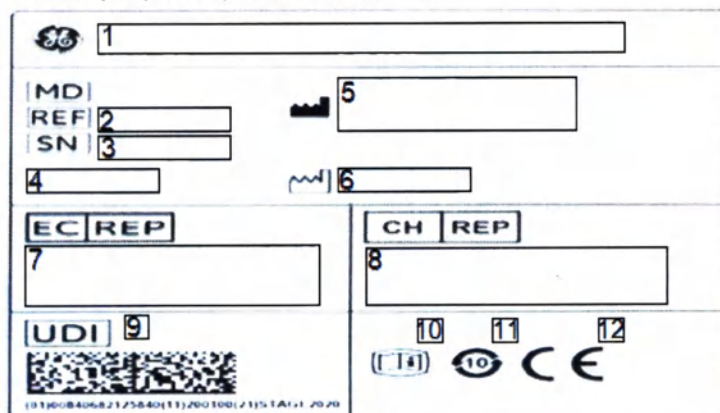

Примечания:	
*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;	
1.	Наименование изделия
2.	Номер по каталогу
3.	Номер серии
4.	Страна сборки
5.	Наименование и адрес производителя
6.	Дата производства
7.	Авторизованный Представитель в ЕС
8.	Авторизованный Представитель в Швейцарии
9.	UDI (Уникальный идентификатор устройства) и матричный штрихкод
10.	Обратитесь к инструкции по применению
11.	Символ содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
12.	Знак CE

Устройство для записи ультразвуковых изображений на CD и DVD диски - DVD/CD Drive LiteON

Макет маркировки изделия:

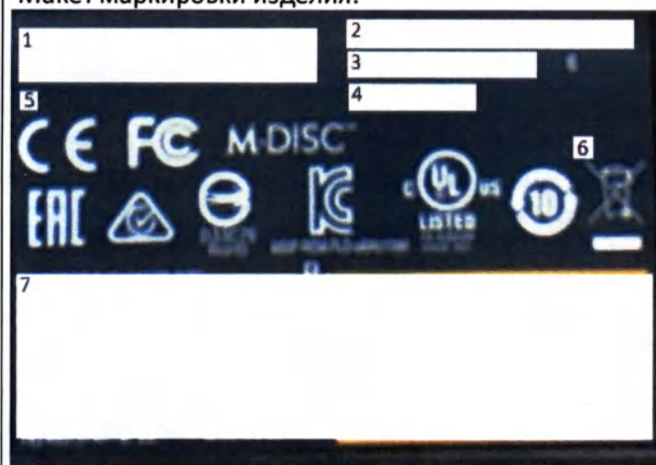

Model

 S.N.
 Manufactured Date


1	Логотип изготовителя
2	Наименование изделия
3	Модель
4	Параметры электропитания
5	Символы соответствия зарубежным стандартам (не применимо для РФ)
6	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
7	Предупреждающие надписи
8	Модель
9	Серийный номер
10	Дата изготовления

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения SONY, Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения SONY

Макет маркировки изделия:

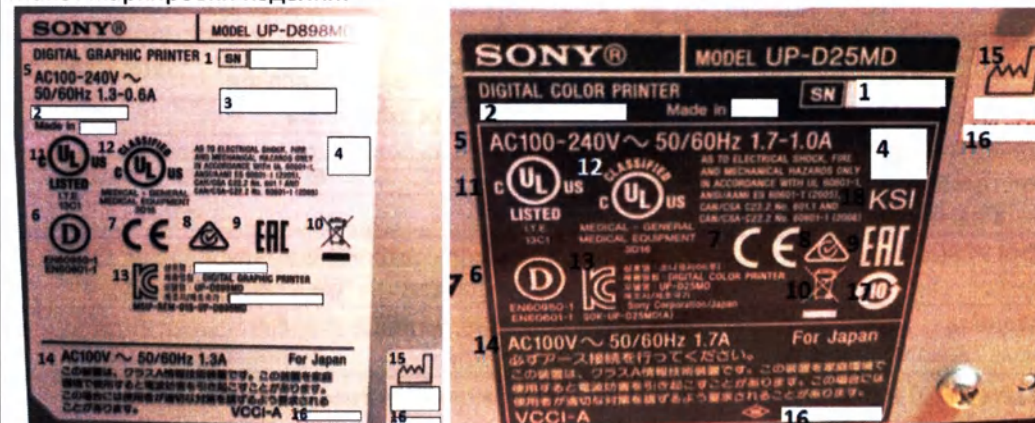


SONY	Логотип производителя
Model	Модель
Digital graphic printer	Цифровой графический принтер
1	Серийный номер
2	Производитель
Made in	Страна изготовитель
3	Штрихкод
4	Уникальный идентификатор устройства и матричный штрихкод
5	Требования к источнику питания
6, 8, 11, 12, 13, 18	Символы соответствия, информация о соответствии зарубежным стандартам (не применимо для РФ)
7	Знак CE
9	Единый знак соответствия требованиям к продукции для обращения в странах Евразийского экономического союза.
10	Этот символ означает, что после списания данное оборудование не следует выбрасывать на свалку — оно должно быть утилизировано в специально предназначенном для этого месте.
Digital color printer	Цифровой цветной принтер
14	Информация для Японии
15	Дата изготовления
16	Номер чертежа
17	Символ для Китая

Примечания:

- * на маркировке также может быть указана дополнительная информация;
- * информация может быть указана на отдельных маркировках;
- * дата выпуска указывается отдельно.

Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения

Макет маркировки упаковки изделия:

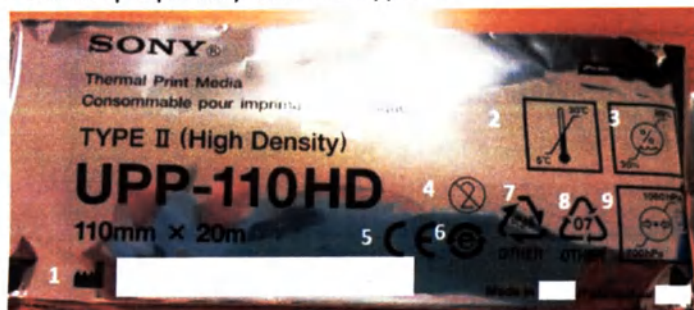

SONY	Логотип производителя	2	Температурный диапазон
Thermal Print Media	Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения	3	Диапазон влажности
		4	Заперт на повторное применение
		5	Знак CE
TYPE II (High density)	Тип 2 (Высокая плотность)	6, 7	Символ соответствия зарубежным стандартам (не применимо для РФ)
UPP-110 HD	Модель	8	Символ утилизации. Остальные виды пластика
110mm x 20 mm	110мм x 20 мм (размер бумаги)	9	Ограничение атмосферного давления
1	Производитель	Made in	Страна изготовитель

Примечания:

- * на маркировке также может быть указана дополнительная информация;
- * информация может быть указана на отдельных маркировках;

Накладки на клавиатуру, Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера - CWD kit, Устройство, обеспечивающее возможность беспроводной передачи данных, Полки для принтера для док-станции, Защитный чехол для системы ультразвуковой диагностической, Кабели для подключения устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения, Крепление для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения.

Макет маркировки упаковки изделия:

1. GE logo

HCAT: 3

DESC: 4

2. Barcode

Примечания:

- * на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип изготовителя
2.	Наименование и адрес производителя
3.	HCAT номер
4.	Наименование изделия

Дополнительные ящики для тележки

Макет маркировки упаковки изделия:

1. GE logo

HCAT: 3

GPN: 2

DESC: 4

5. Manufacturer's name and address

6. Small field at the bottom

Примечания:

- * на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип изготовителя
2.	GPN номер
3.	HCAT номер
4.	Наименование изделия
5.	Наименование и адрес производителя
6.	Страна изготовления

Док-станция для ультразвуковой системы мобильная с возможностью подключения к сети

Макет маркировки изделия:

1		2		9		10		11	
名称 DESC :	3	型号 MODEL :	4	12		13			
仅供LOGIQ e (软件版本 R 8. X. X及以上版本) 系列使用									
5				14		15			
输入 INPUT : 100-240V~ . 50/60Hz, 350VA 输出 OUTPUT : 20V = 15A				6			16	CISPR 11 / EN 55011 CLASS : A GROUP : 1 CLASSE : A GROUPE : 1	
				8					


Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип изготовителя
2.	Наименование и адрес производителя
3.	Наименование изделия
4.	Модель
5.	Для использования только с Logiq e (Версия ПО R 8.X.X и выше)
6.	Входные параметры электропитания
7.	Выходные параметры электропитания
8.	Страна изготовления
9.	Обратитесь к сопроводительной документации
10.	Общее предостережение
11.	Осторожно! Опасное напряжение
12.	Не используйте вблизи данного оборудования следующие устройства: сотовые телефоны, радиоприемники, радиопередатчики для мобильной связи, радиоуправляемые игрушки и т. д. Использование таких устройств вблизи оборудования может повлиять на заявленные технические характеристики устройства. Если перечисленные устройства находятся вблизи оборудования, следует выключить их источники питания
13.	Не толкайте систему
14.	Символ содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
15.	Отходы данного электрического и электронного оборудования следует собирать отдельно от неотсортированных бытовых отходов и утилизировать соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации
16.	Классификация изделия

Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов с комплектом кабелей

Макет маркировки изделия:

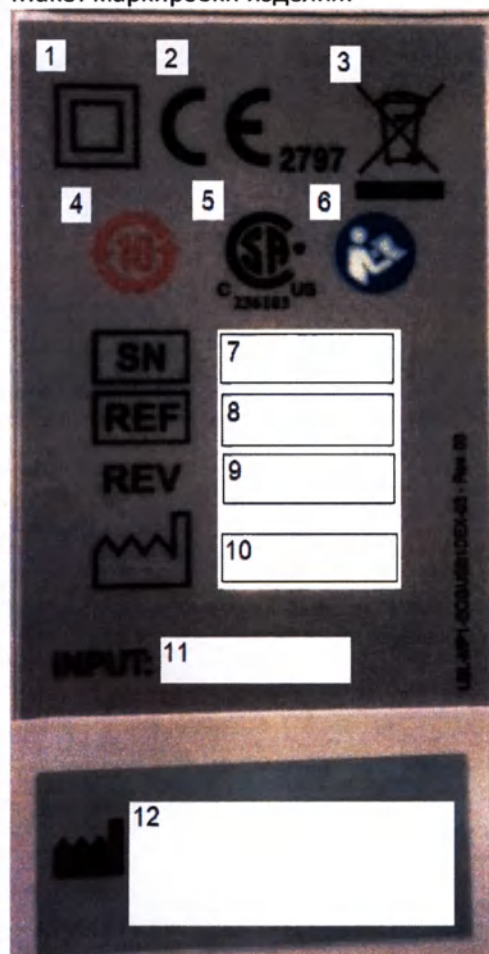

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Класс электрооборудования II
2.	Знак CE
3.	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
4.	Символ содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
5.	Символы соответствия, информация о соответствии зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
6.	Обратитесь к сопроводительной документации
7.	Номер серии
8.	Номер по каталогу
9.	Рев. номер
10.	Дата производства
11.	Входные параметры электропитания
12.	Наименование и адрес производителя

Сумка для транспортировки для системы ультразвуковой диагностической

Макет маркировки упаковки изделия:



P/N :1



S/N :2

3

Model: 4

Volume: 5

Quantity: 6

7

8

Customer's Code: 9

Production Date: 10

Supplier Code: 11

Specification: 12

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Парт номер
2.	Номер серии
3.	Наименование производителя
4.	Модель
5.	Размеры
6.	Количество
7.	Масса нетто
8.	Масса брутто
9.	Код клиента
10.	Дата производства
11.	Код поставщика
12.	Спецификация

Аккумуляторная батарея

Макет маркировки изделия:

25 50 75 100

TEST 1

2

3

产品名称: 可充电电池组
Model / 型号: 4

5 额定容量: 6

Limited charge voltage/
充电限制电压: 7 41NR19/66-2

8

为避免引起火灾、爆炸或燃烧, 请不短路、撞击、
焚烧、拆解电池。电池的环境温度请不超过80°C。
电池浸水后禁止使用。

9 10 11 12

13 14

Li-Ion C RU US MH 29443

15

惠州隆基电子有限公司

16

IS16046/IEC62133

17

18 REF 19

SN 20

2019-05

R-41039896
www.bis.gov.in

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип изготовителя
2.	Наименование и адрес производителя
3.	Наименование изделия
4.	Модель
5.	Выходное напряжение
6.	Выходные параметры электропитания
7.	Предельное напряжение зарядки
8.	Предупреждающие надписи
9.	Обратитесь к сопроводительной документации
10.	Не помещайте аккумулятор в огонь
11.	Не разбирайте аккумулятор и обращайтесь с ним надлежащим образом
12.	Отходы данного электрического и электронного оборудования следует собирать отдельно от

	неотсортированных бытовых отходов и утилизировать соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации
13.	Общее предостережение
14.	Переработка литий-ионных аккумуляторов
15.	Место производства
16.	Адрес производства
17.	Страна сборки
18.	Дата производства
19.	Номер по каталогу
20.	Номер серии

Мобильная тележка для перемещения системы ультразвуковой диагностической

Макет маркировки изделия:

Примечания:
*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип изготовителя
2.	Наименование, адрес производителя
3.	Наименование изделия
4.	Модель
5.	Для использования с Logiq e: Версия ПО R 8.X.X и выше
6.	«Обратитесь к сопроводительной документации»
7.	Общее
8.	«Осторожно! Опасное напряжение»
9.	Не толкайте систему
10.	Уровень содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/ T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных

	веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
11.	Данное электрическое и электронное оборудование и его отходы следует утилизировать отдельно от неотсортированных бытовых отходов соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации.
12.	Классификация изделия
13.	Номер по каталогу
14.	Номер серии
15.	Дата производства
16.	Входные параметры электропитания
17.	Выходные параметры электропитания
18.	Страна изготовления
19.	Место производства

Адаптер 3-х портовый для подключения датчиков

Макет маркировки упаковки изделия:

1



P/N: Rev.

H CAT:

DESC:

P/N: 

H CAT: 



7

6

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип изготовителя
2.	Парт номер
3.	HCAT номер
4.	Наименование изделия
5.	Рев. номер
6.	Страна изготовления
7.	Наименование производителя

Кабель электропитания

Макет маркировки изделия:

	1
	Part number: 2
	PI Revision: 3
	Date code: 4
	Facility code: 5
	6
7	

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Наименование производителя
2.	Парт номер
3.	Рев номер
4.	Дата производства
5.	Код места производства
6.	Страна производства
7.	Дублирование (парт номер/рев номер/дата производства/код места производства/страна производства)

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

Макет маркировки изделия:

1	11	12	13	
2	14	15	16	17
MODEL: 3	18			
INPUT: 4				
OUTPUT: 5				
NO-LOAD POWER CONSUMPTION<0.5W				
AVERAGE ACTIVE EFFICIENCY>90%				
6	8	REV10		
	9			
7				

Примечания:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация;

1.	Логотип производителя
2.	Наименование изделия
3.	Номер модели
4.	Входные параметры электропитания
5.	Выходные параметры электропитания
6.	Наименование производителя
7.	Страна производства
8.	Парт номер
9.	Номер серии

10.	Рев номер
11.	Для использования внутри помещений
12.	«Осторожно! Опасное напряжение»
13.	Символы соответствия зарубежным стандартам (не применимо для РФ)
14.	Разводка выводов
15.	Общее
16.	Данное электрическое и электронное оборудование и его отходы следует утилизировать отдельно от неотсортированных бытовых отходов соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации
17.	Степень защиты от проникновения воды или твердых частиц
18.	Этот символ означает, что уровень содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/ T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *Алиханов*
10 листа(ов)

