

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»


Е.В. Варлыгин
« 20 » сентября 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Дилуэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в вариантах исполнения»,
производства Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd., Китай**

Рисунок. Дилуэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в вариантах исполнения. Дилуэнт KU-R02-1



KEYU

Sample Diluent

KEYU

【Intend Use】

The Sample Diluent is used to dilute and liquefy the sample to be tested, so as to facilitate the detection of the substance to be tested by the instrument. It is not directly involved in the detection itself.

【Cautions】

1. This product is a reagent for in vitro detection and should not be taken orally.
2. It should not be in contact with eyes and skin. If it is accidentally polluted, it should be rinsed with clean water immediately.

Please see instructions for details.

IVD



Model: KU-R02-1

Specification: 5 L/B

LOT A240100

2301202

2207202

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.
Add: 14-3F Building 2, No. 218, Yugu Road, Suncast Town, Zhuhai
District, Zhuhai City, P.R. China

CE Logo ME & V
Address: Eindhoven Sciencepark 10, 18 Veld, 2004-6, The Hague, Netherlands
NO: NMA12-5

【INSTRUCTIONS】


1. Remove the portion at the dashed lines.
2. Pull out the cap of the container.
3. Connect to the tubing of the instrument.

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.
Add: 1/F, 2/F, Building 2, No. 605, Yuge Road, Zhuhai City, P.R. China
Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169
Website: www.keyubio.com Email: keyubio.com



SIZE: 210mm X 190mm X 185mm

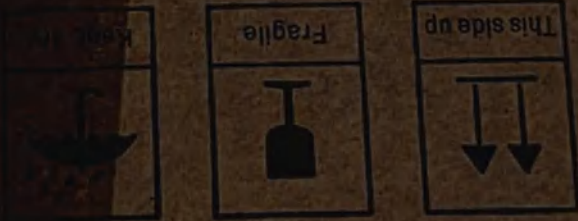

KEYU

Диплоент для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU.
Вариант исполнения Диплоент KU-R02-1, в составе:

- 1.1 Диплоент, 5 л – 1 шт;
- 1.2 Электронный ключ – 1 шт;
- 1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.
Адрес: 1/Е, 2/Е, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China
Место производства медицинского изделия
Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.
1/Е, 2/Е, 5/Е, 6/Е, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China
Уполномоченный представитель производителя в РФ
ООО «КИФА»;
Адрес: 109316, г. Москва, вост.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт
Волгоградский, д. 43 к. 3
Телефон: +7 (495) 925-56-00
Для профессионального применения
Регистрационное удостоверение №_от_

Код партии  дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном
представителе в Европейском сообществе  указаны на оригинальной упаковке.



(INSTRUCTION)

- 1. Remove the
- 3. Connect to


at the dashed lines. 2. Pull out the cap of the container.
g of the Instrument.

Open here
to check
the amount
of liquid
remaining

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.



Рисунок. Дилуэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в вариантах исполнения. Дилуэнт KU-R02-2

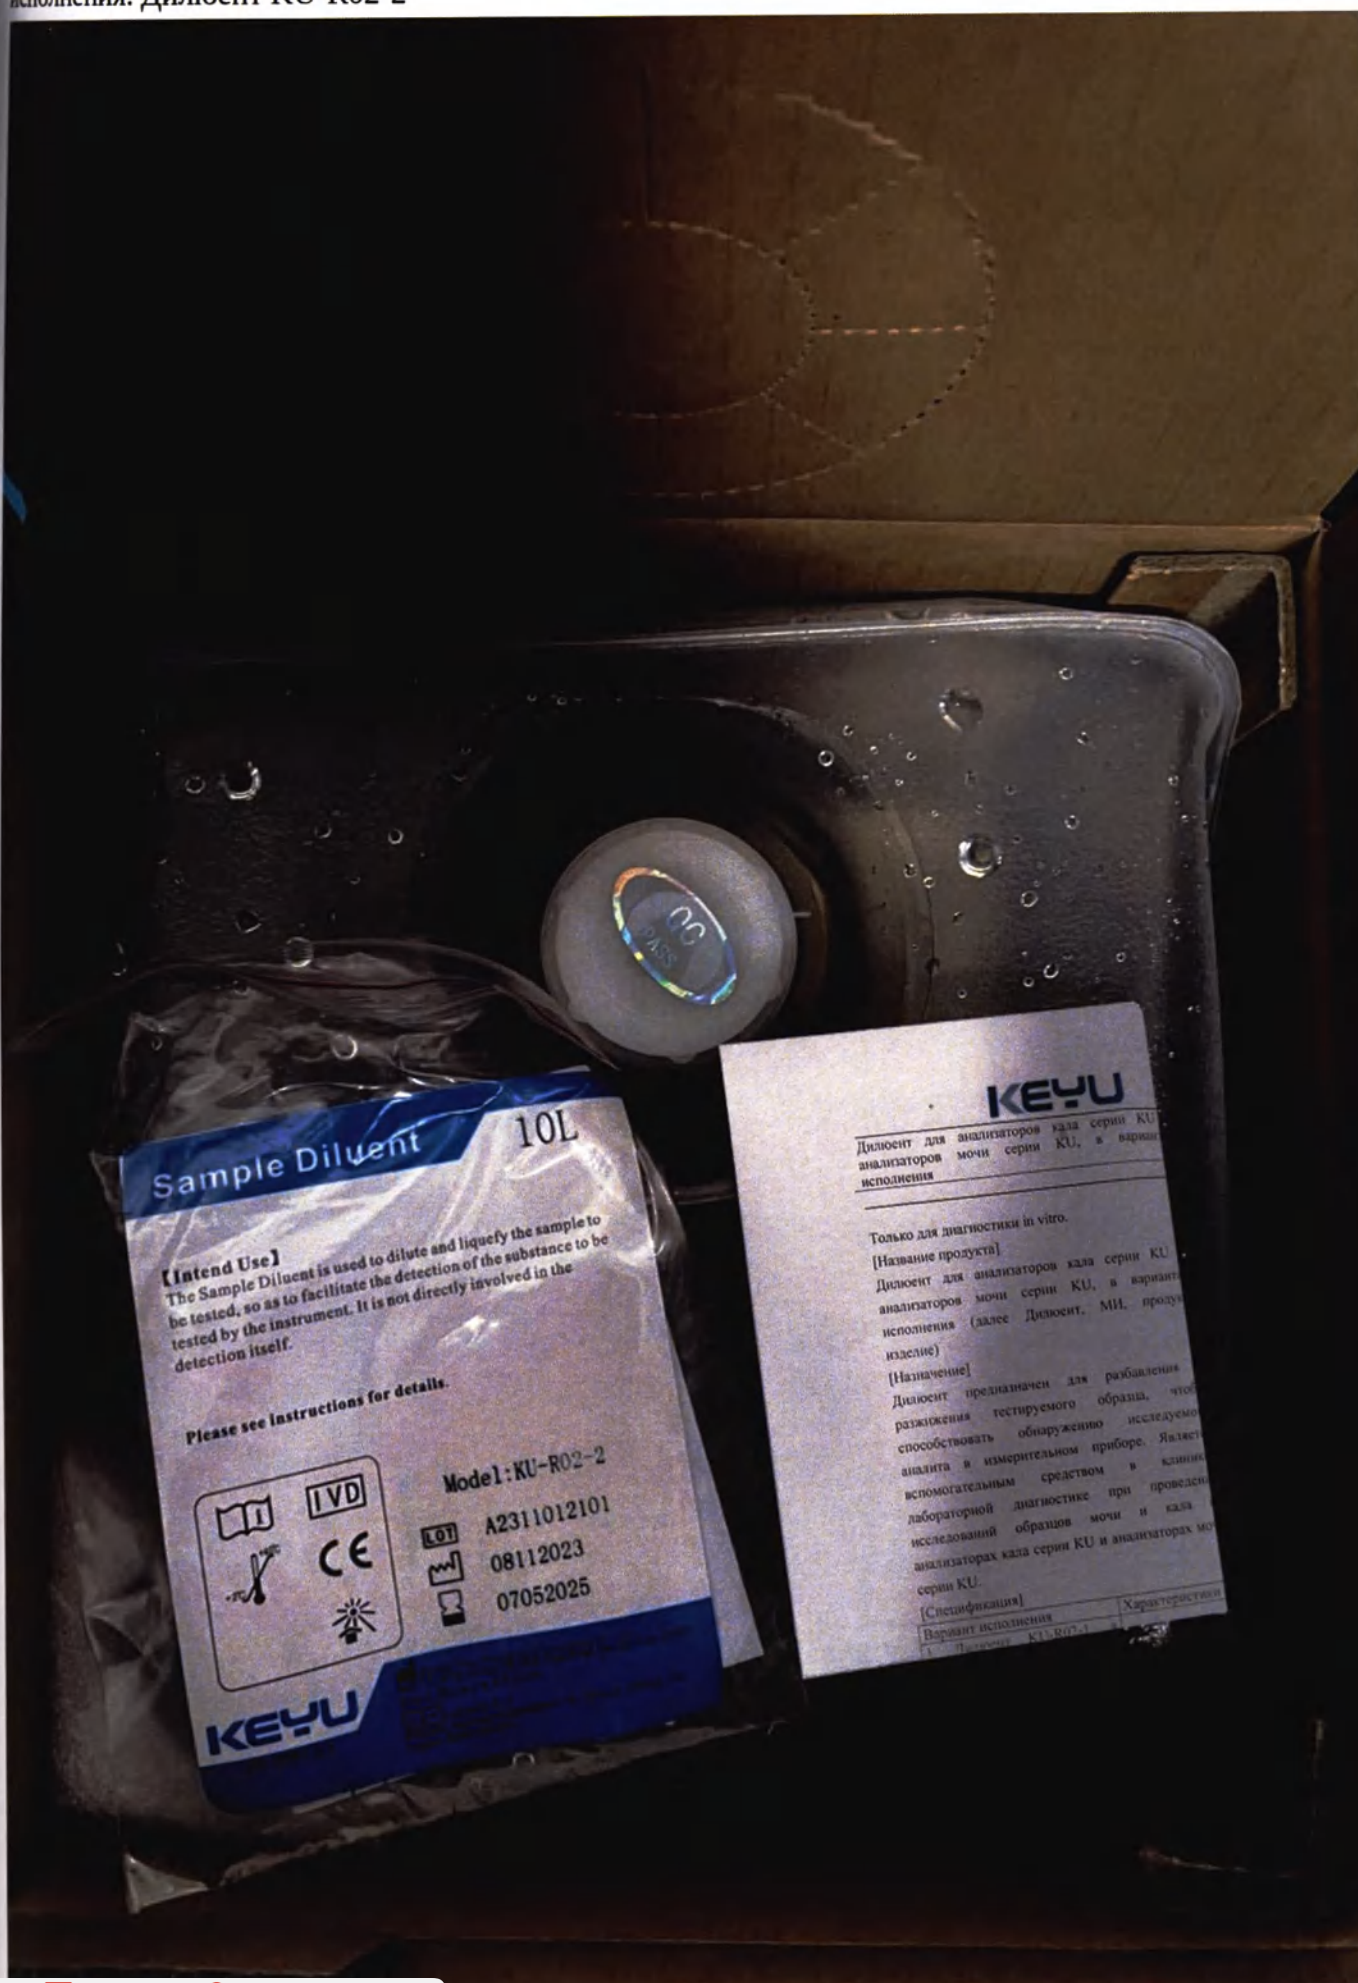

Sample Diluent 10L

[Intend Use]
The Sample Diluent is used to dilute and liquify the sample to be tested, so as to facilitate the detection of the substance to be tested by the instrument. It is not directly involved in the detection itself.

Please see instructions for details.



Model: KU-R02-2
A2311012101
08112023
07052025

KEYU

KEYU

Дилуэнт для анализаторов кала серии KU
анализаторов мочи серии KU, в вариантах
исполнения

Только для диагностики in vitro.

[Название продукта]
Дилуэнт для анализаторов кала серии KU,
анализаторов мочи серии KU, в вариантах
исполнения (далее Дилуэнт, МН, продукт,
изделие)

[Назначение]
Дилуэнт предназначен для разбавления,
разжижения тестируемого образца, что
способствует обнаружению исследуемого
аналита в измерительном приборе. Является
вспомогательным средством в клинической
лабораторной диагностике при проведении
исследования образцов мочи и кала в
анализаторах кала серии KU и анализаторах мочи
серии KU.

[Спецификация]	Характеристики
Вариант исполнения	
1. Дилуэнт KU-R02-1	



KEYU

Sample Diluent

KEYU

【Intend Use】

The Sample Diluent is used to dilute and liquify the sample to be tested, so as to facilitate the detection of the substance to be tested by the instrument. It is not directly involved in the detection itself.

【Cautions】

1. This product is a reagent for in vitro detection and should not be taken orally.
2. It should not be in contact with eyes and skin. If it is accidentally polluted, it should be rinsed with clean water immediately.

Please see instructions for details.



Model: KU-R02-2

Specification: 10 L/Bucket

LOT

I2408001101



06082024



05022026



【INSTRUCTIONS】

1. Remove the portion at the dashed lines.
2. Pull out the cap of the
3. Connect to the tubing of the instrument.

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co.




This side up



Fragile




Keep dry



Stacking limit
number

SIZE: 240mm X 240mm X 246mm



Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Add: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Jinwan Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China


Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169


Website: www.keyubio.com Email: export@keyubio.com

NO. RUA



сунок. Дилуэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в вариантах исполнения. Дилуэнт KU-R02-3

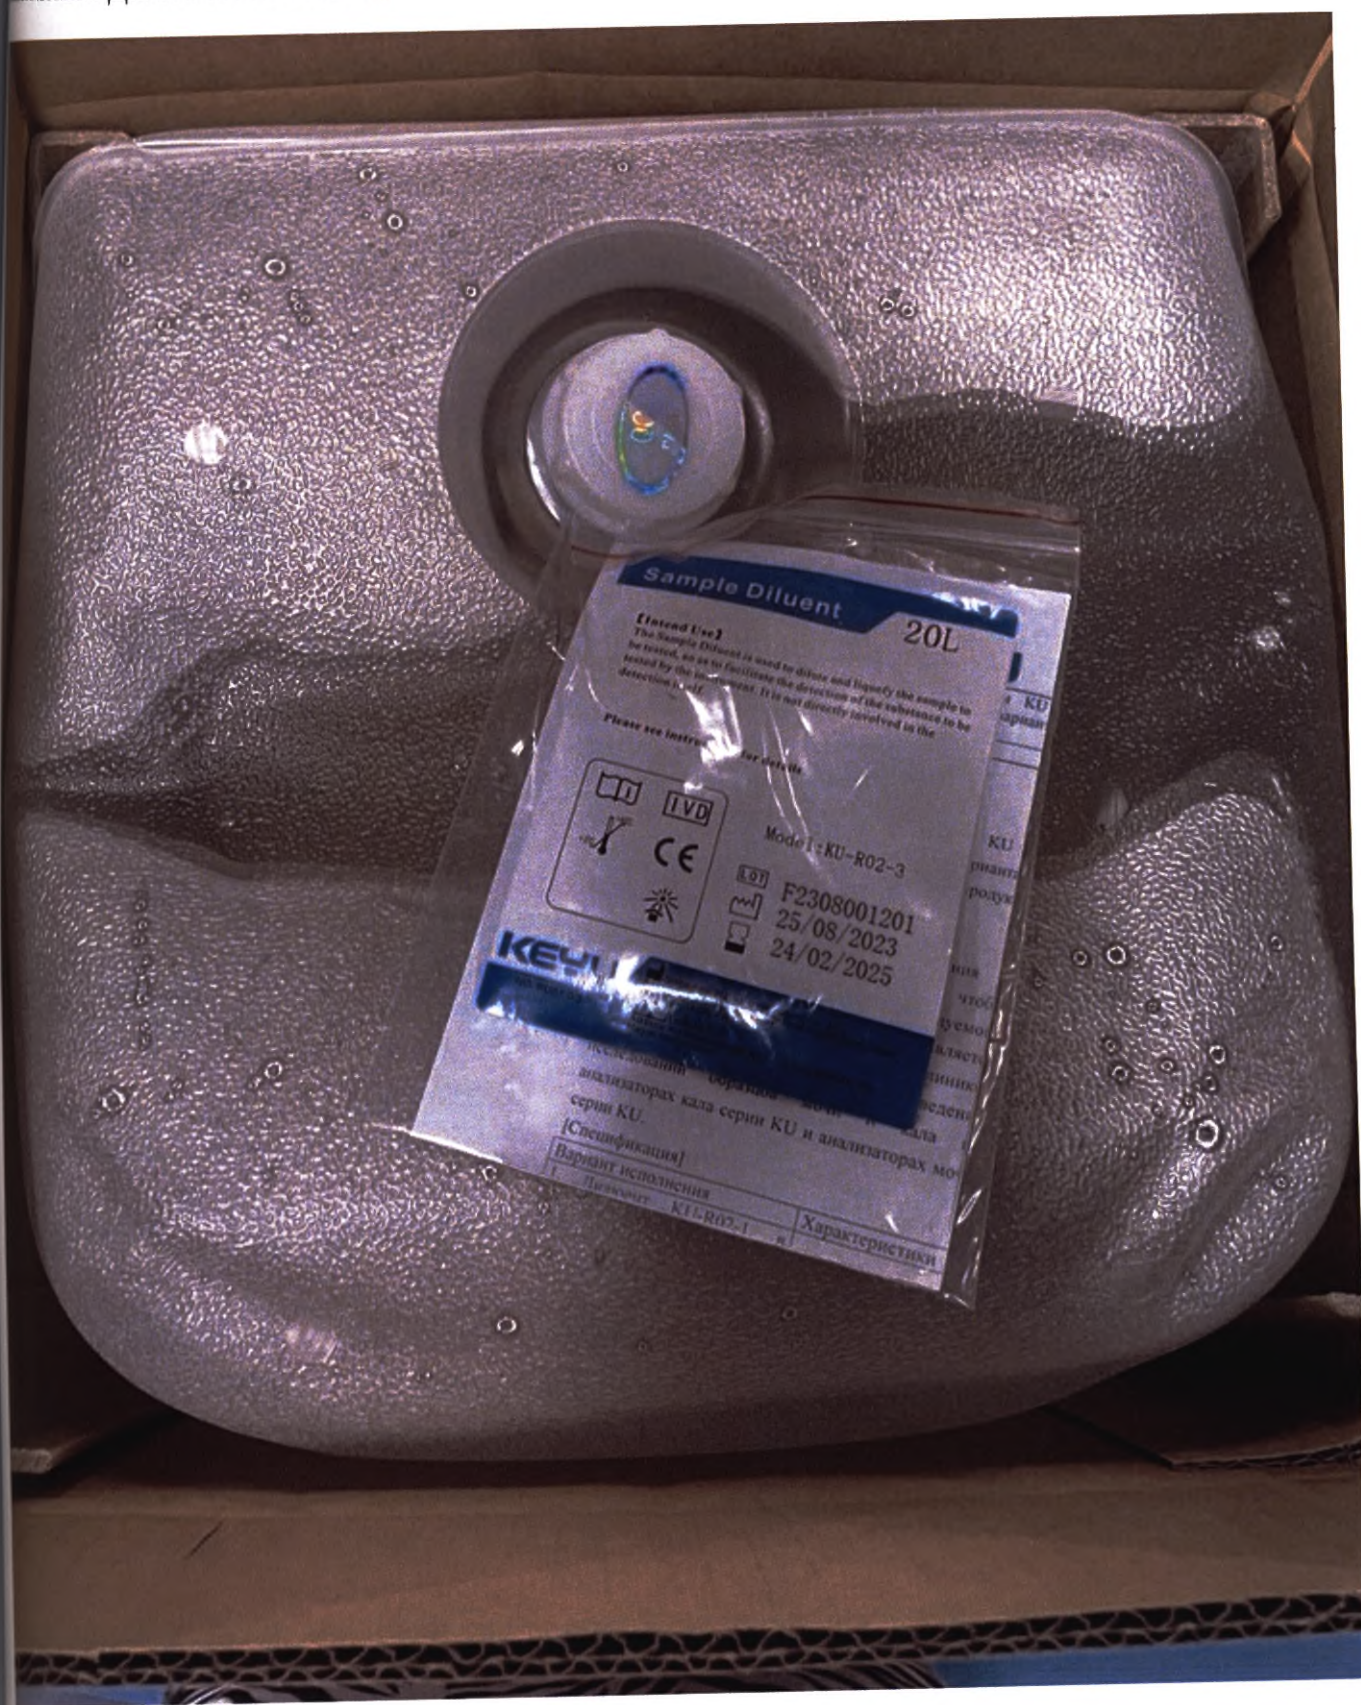

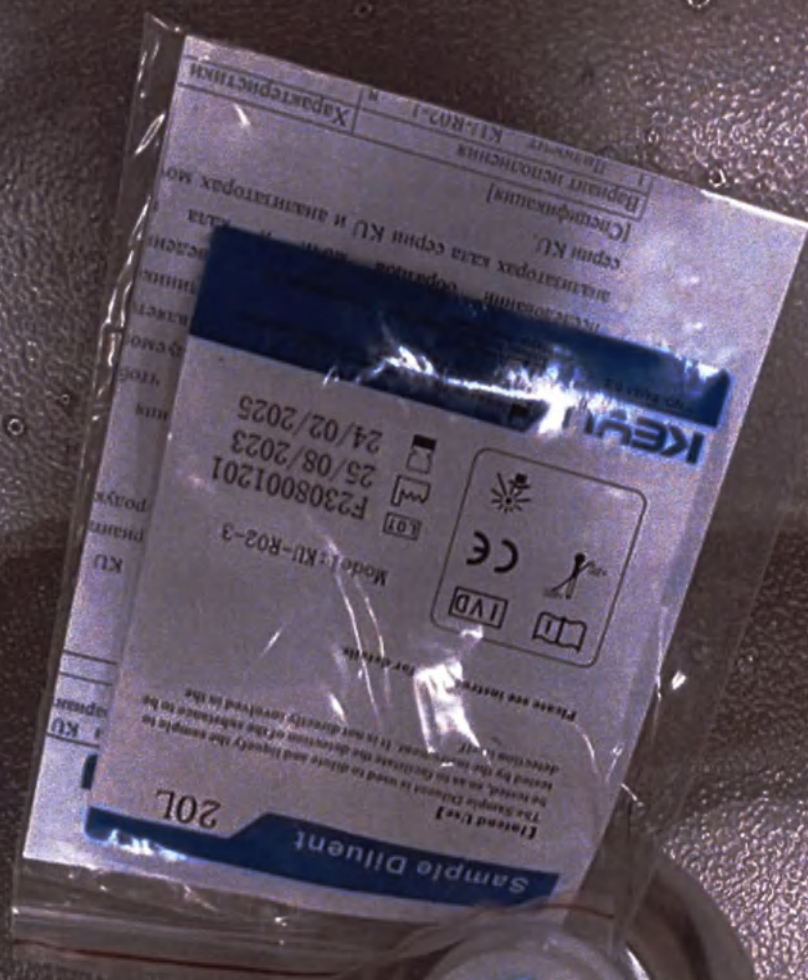

KEYU

Sample Diluent

KEYU

【Intend Use】

The Sample Diluent is used to dilute and liquefy the sample to be tested, so as to facilitate the detection of the substance to be tested by the instrument. It is not directly involved in the detection itself.

【Cautions】

1. This product is a reagent for in vitro detection and should not be taken orally.
2. It should not be in contact with eyes and skin. If it is accidentally polluted, it should be rinsed with clean water immediately.

Please see instructions for details.



Model: KU-R02-3

Specification: 20 L/Bucket

LOT F2308001201
25/08/2023
24/02/2025


CE

【INSTRUCTIONS】

1. Remove the portion at the dashed lines
2. Pull out the cap of the container.
3. Connect to the tubing of the instrument

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

[illegible]



This side up



Fragile



Keep dry



Stacking limit
by number

SIZE: 298mm X 298mm X 2



Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.


Add: 1/f, 2/f, Building 2, 605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan

District, Zhuhai City, P.R. China

Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169

Website: www.keyubio.com Email: export@keyubio.com

O. RUA



This side up



Fragile



Keep dry

SIZE: 298mm X 298mm X 280mm



Stacking limit
Number



Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.


Add: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169

Website: www.keyubio.com Email: info@keyubio.com

NG-RU

THIS SIDE UP

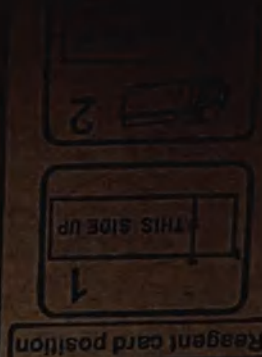

Remove center
circular part



Propose soft
bucket port





Lift peripheral
pages



Return the fan page back
to the original position
and stuck in soft bucket port

унок. Дилуэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в вариантах исполнения. Дилуэнт KU-R02-5

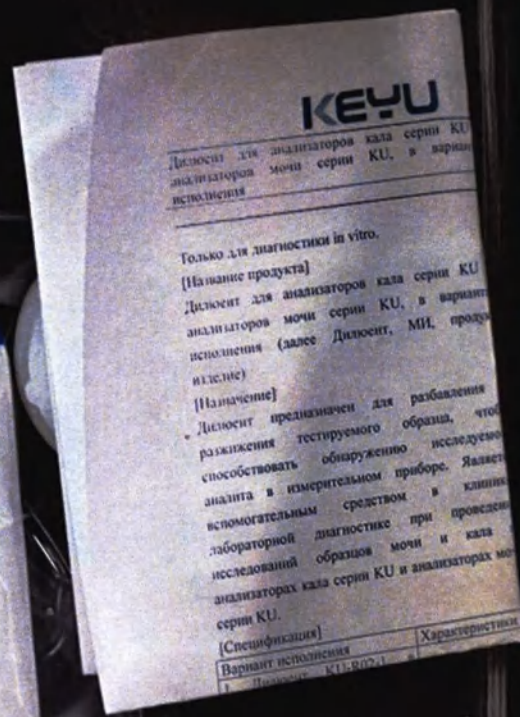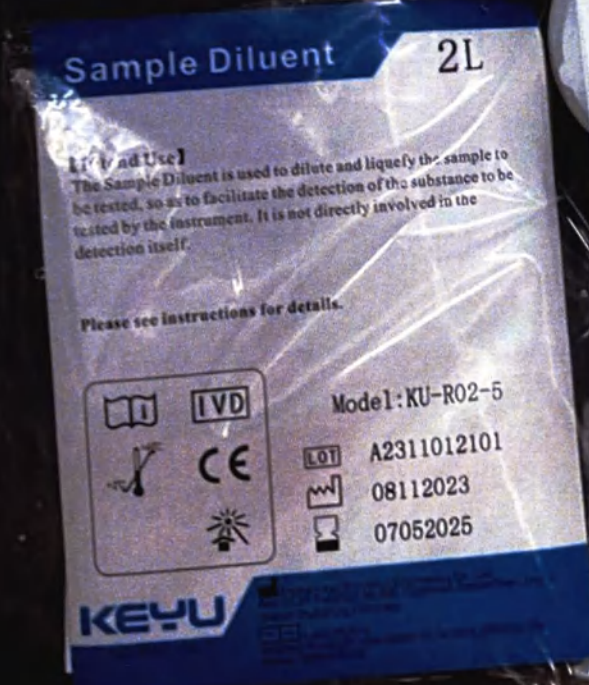

KEYU

Sample Diluent

KEYU

【Intend Use】

The Sample Diluent is used to dilute and liquefy the sample to be tested, so as to facilitate the detection of the substance to be tested by the instrument. It is not directly involved in the detection itself.

【Cautions】

1. This product is a reagent for in vitro detection and should not be taken orally.
2. It should not be in contact with eyes and skin. If it is accidentally polluted, it should be rinsed with clean water immediately.

Please see instructions for details.

IVD



Model: KU-R02-5

Specification: 2 L/Bucket

LOT A2311010101

29112023

28052025

CE

【INSTRUCTIONS】

1. Remove the portion at the dashed lines.
2. Pull out the cap of the container.
3. Connect to the tubing of the instrument.

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Дилуэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU.
Вариант исполнения Дилуэнт KU-R02-5, в составе:

- 1.1 Дилуэнт, 2 л – 1 шт;
- 1.2 Электронный ключ – 1 шт;
- 1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City,
P.R.China

Место производства медицинского изделия

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»:

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт
Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № от

Код партии **LOT**, дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном представителе в Европейском сообществе  указаны на оригинальной упаковке.



[INSTRUCTIONS]

1. Remove the portion at the dashed line.
2. Pull out the cap of the container.
3. Connect to the tubing of the instrument.

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd



This side up



Fragile



Keep dry



Stacking limit
by number

SIZE: 130mm X 150mm X 176mm



Zhuhai Keyu Biological Engineering

Add: 1/F, 2/F, Building 2, No. 605, Yuge Road, Sanzhi
District, Zhuhai City, P.R. China

Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169

Website: www.keyubio.com Email: export@keyubio.com

NO. RUA

Zhuohai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.
 Add: 1/A, 2/F, Building 2, No. 605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan
 District, Zhuhai City, P.R. China
 Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169
 Website: www.keyubio.com Email: export@keyubio.com
NO. RUA



SIZE: 130mm X 150mm X 176mm

 Stacking limit by number	 Keep dry	 Fragile	 This side up
---------------------------------	--------------	-------------	------------------





пакет маркировки для обращения на территории РФ

Диллюэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторах мочи серии KU.

Вариант исполнения Диллюэнт KU-R02-1, в составе:

1.1 Диллюэнт, 5 л – 1 шт;

1.2 Электронный ключ – 1 шт;

1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства медицинского изделия

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт


Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии **LOT**, дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном

представителе в Европейском сообществе  указаны на оригинальной упаковке.



Диллюэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторах мочи серии KU.

Вариант исполнения Диллюэнт KU-R02-2, в составе:

1.1 Диллюэнт, 10 л – 1 шт;

1.2 Электронный ключ – 1 шт;

1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства медицинского изделия

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;


Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт

Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии		дата изготовления		срок годности		данные об Уполномоченном
						
представителе в Европейском сообществе _____ указаны на оригинальной упаковке.						
    						

Диплоент для анализаторов кала серии KU и анализаторах мочи серии KU.

Вариант исполнения Диплоент KU-R02-3, в составе:

1.1 Диплоент, 20 л – 1 шт;

1.2 Электронный ключ – 1 шт;

1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства медицинского изделия

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;


Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии , дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном

представителе в Европейском сообществе  указаны на оригинальной упаковке.



Диллюэнт для анализаторов кала серии KU и анализаторах мочи серии KU.

Вариант исполнения Диллюэнт KU-R02-5, в составе:

1.1 Диллюэнт, 2 л – 1 шт;

1.2 Электронный ключ – 1 шт;

1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства медицинского изделия

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ


ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии , дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном представителе в Европейском сообществе  указаны на оригинальной упаковке.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

30 (тридцать)

лист(-ов),

Генеральный директор ООО «КИФА»

Е.В.Варлыгин

