

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»




Е.В. Варлыгин

«18» сентября 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Раствор чистящий концентрированный KU-W-01 для анализаторов кала серии KU и анализаторов
мочи серии KU»**

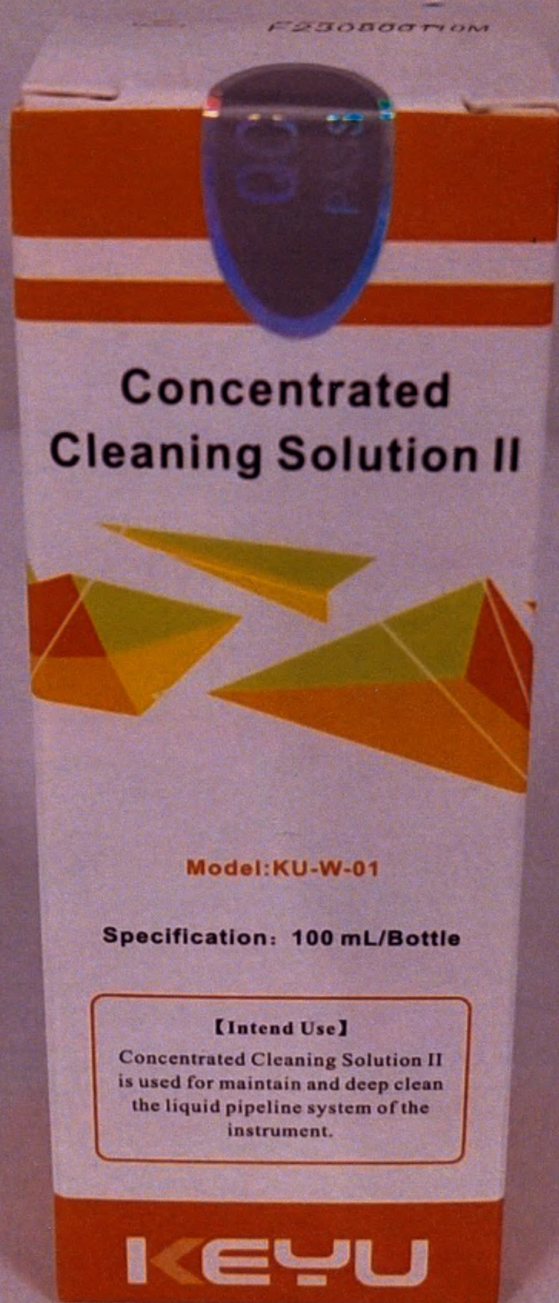

IVD



【Cautions】

1. This product is a reagent for in vitro detection and should not be taken orally.
2. Do not contact with eyes or skin.
If it is accidentally contaminated, rinse it off with clean water immediately.

Please see instructions for details.

Корпус

Раствор чистящий концентрированный KU-W-01 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в составе:

1. Раствор чистящий концентрированный, 100 мл – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ
ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ
Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Состав изделия, номер серии, срок годности, условия хранения
указаны на оригинальной упаковке.

Код партии , дата изготовления , срок годности 
данные об Уполномоченном представителе в Европейском сообществе

EC REP

указаны на оригинальной упаковке.

IVD




Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Add: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao

Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R. China

Tel: 86-0756-682 1168 Fax: 86-0756-6821169

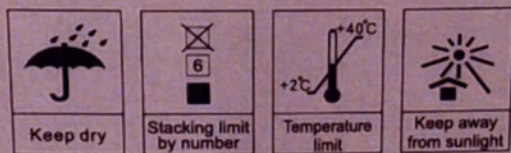


NO. RUA1.0.0



25/08/2023



24/02/2025



F230800110M

Рисунок. Первичная (индивидуальная) упаковка


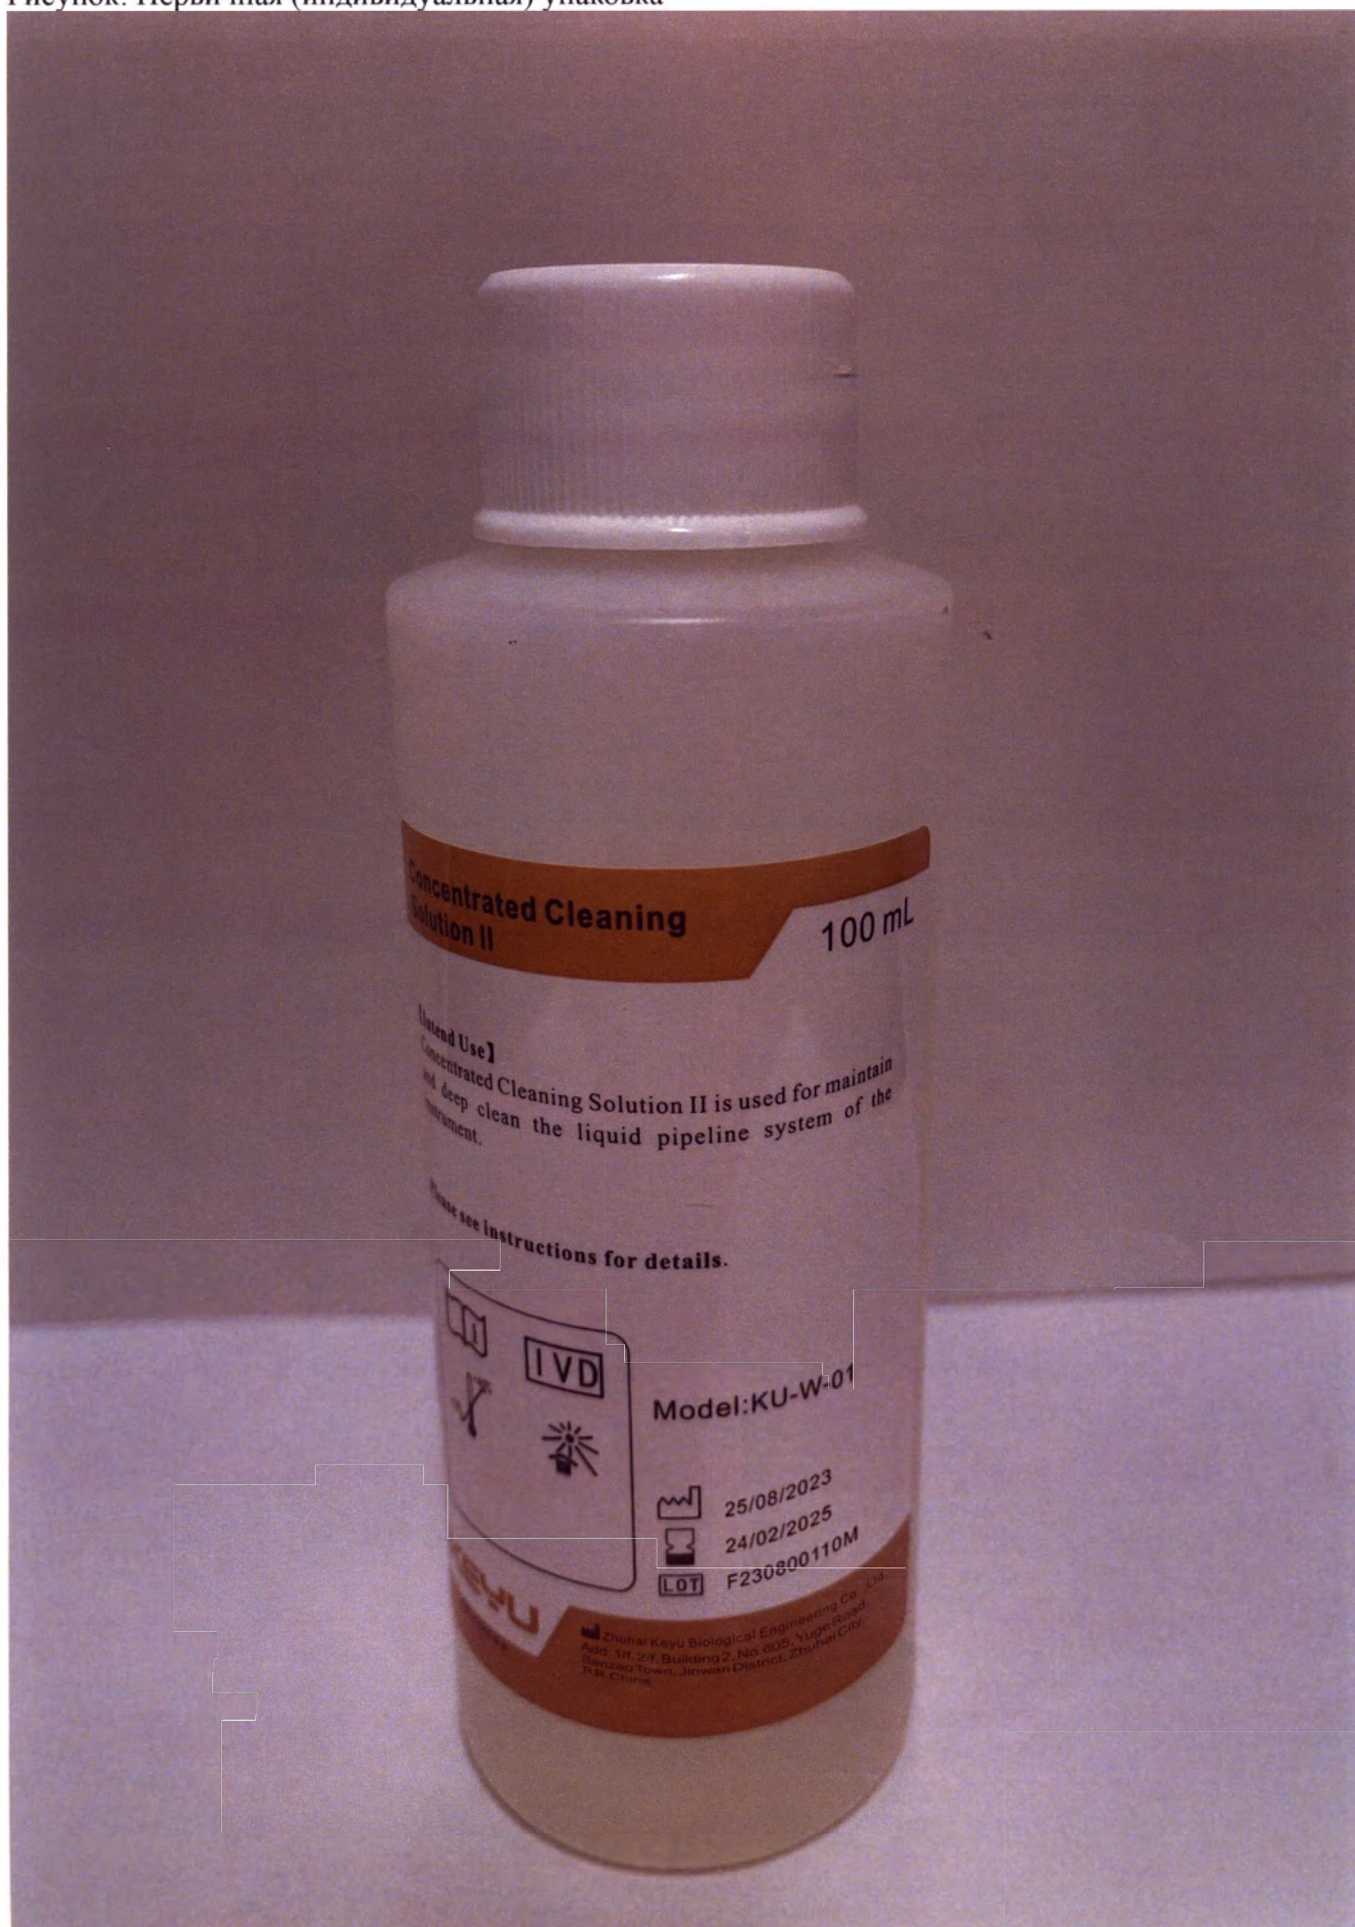


Рисунок. Общий вид (иснтрукция по применению, индивидуальная упаковка)

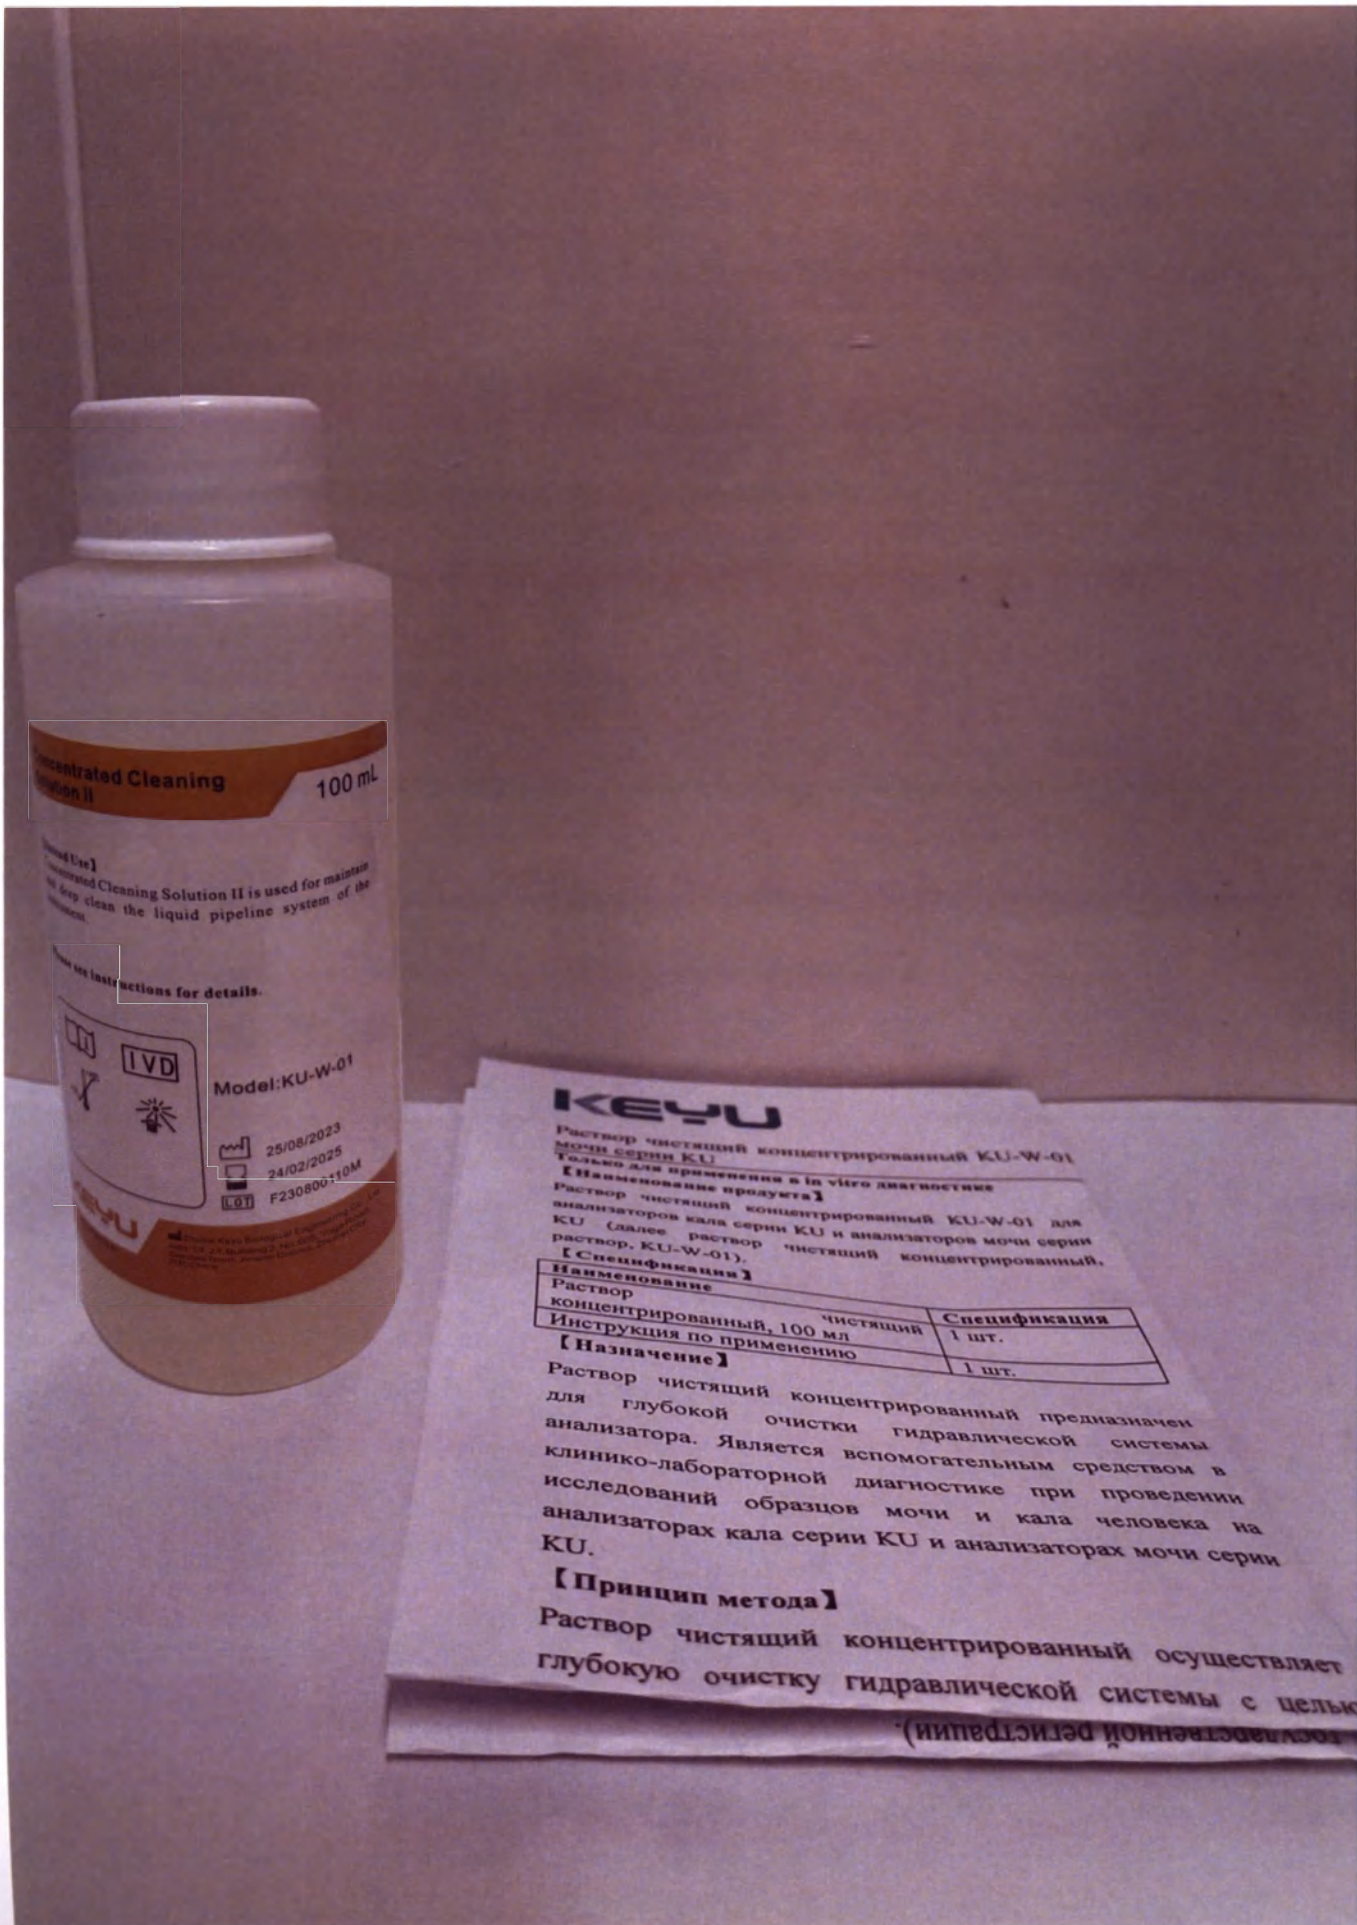

Макет маркировки для обращения на территории РФ

Раствор чистящий концентрированный KU-W-01 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, в составе:

1. Раствор чистящий концентрированный, 100 мл – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Состав изделия, номер серии, срок годности, условия хранения указаны на оригинальной упаковке.

Код партии **LOT**, дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном представителе в

Европейском сообществе **EC REP** указаны на оригинальной упаковке.



прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

9 (Деветь)

лист(-ов),

Генеральный директор ООО «КИФА»

Е.В.Варлыгин

