

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»



Е.В. Варлыгин


« 02 » сентября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Раствор чистящий KU-SW02 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU»

Рисунок 1. Раствор чистящий KU-SW02 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU (общий вид, потребительская упаковка)

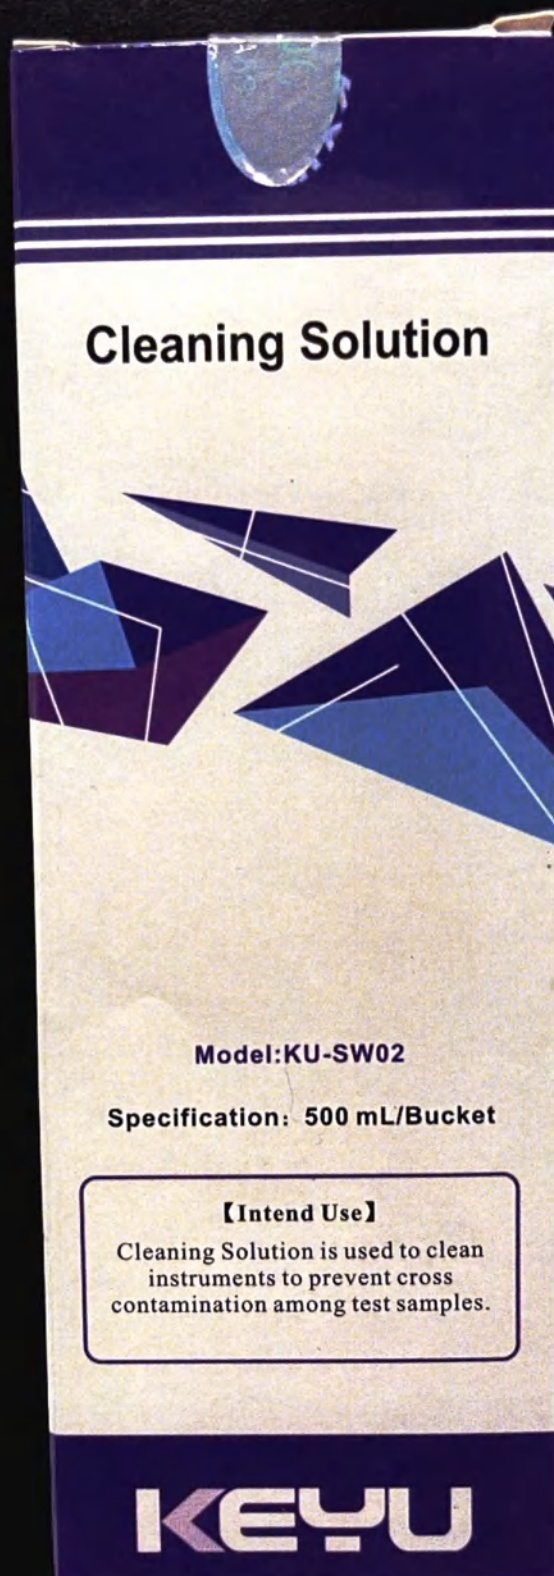

Раствор чистящий KU-SW02 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU в составе:

1. Раствор чистящий, 500 мл – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town,
Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao
Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ
ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ

Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение №_от_____

Код партии , дата изготовления , срок годности , данные
об Уполномоченном представителе в Европейском сообществе



указаны на оригинальной упаковке.




【Cautions】

1. This product is a reagent for in vitro detection and should not be taken orally.
2. Read the instructions carefully before use, use it within the validity period, and take personal safety protection.


KEYU



Keep dry



Stacking limit
by number



Temperature
limit



Keep away
from sunlight



LOT



F230800150M
25082023
24022025



Please see instructions for details.



Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Add: 1/f, 2/f, Building 2, No. 605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R. China

Tel: 86-0756-6821168 Fax: 86-0756-6821169



Lotus NL B.V.

Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595 AA, The Hague, Netherlands

NO. RUA1.0.0

Рисунок 2. Раствор чистящий KU-SW02 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU (индивидуальная упаковка)



Рисунок 3. Раствор чистящий KU-SW02 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU (общий вид, потребительская упаковка, индивидуальная упаковка, инструкция по применению)



прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

7 (Семь) лист(-ов),

Генеральный директор ООО «КИФА»



Е.В.Варлыгин