

## **Фотографические изображения**

**Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO), в вариантах исполнения на 100, 300 тестов**

**ООО «Рош Диагностика Рус»**

Россия, 115114, Москва  
ул. Летниковская, дом 2, стр. 2  
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99  
Факс: +7 (495) 229 62 64

[www.roche.ru](http://www.roche.ru)

**Roche Diagnostics Rus LLC**

2, Letnikovskaya street, bld.2  
Business Center "Vivaldi Plaza"  
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99  
Fax: +7 (495) 229 62 64


[www.roche.ru](http://www.roche.ru)

Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO), в вариантах исполнения на 100, 300 тестов:

1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)

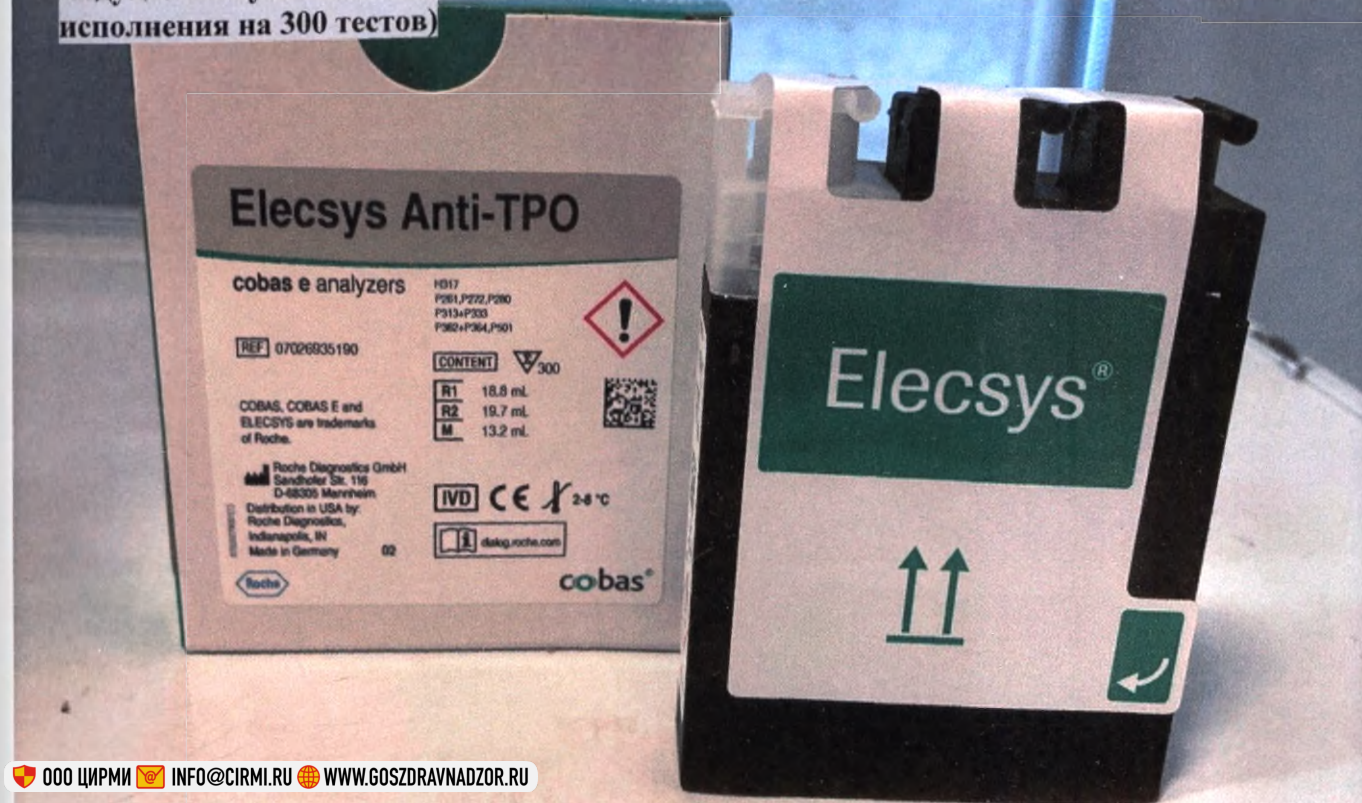

1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов

# Elecsys Anti-TPO

Elecsys and  
cobas e analyzers

**REF** 06368590 190

**CONTENT**

$\Sigma$  100

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>M</b>  | 6.5 mL |
| <b>R1</b> | 9 mL   |
| <b>R2</b> | 9 mL   |

COBAS, COBAS E  
and ELECSYS are  
trademarks of Roche.



 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

**IVD** **CE**  2-8 °C

(0644857001(1))

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

002

 06368590190  
<http://e-labdoc.roche.com>




**cobas**<sup>®</sup>

1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов



1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов

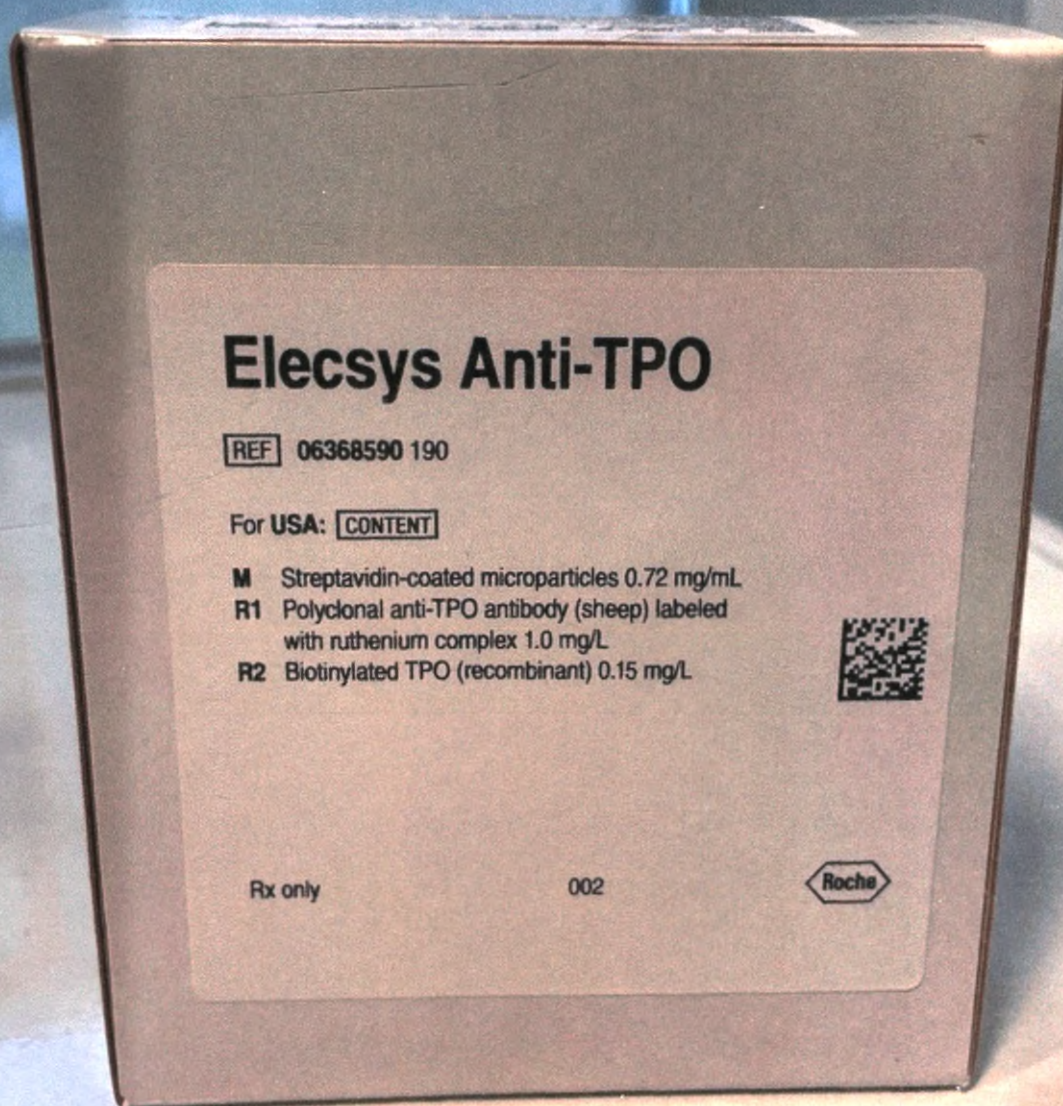

## Elecsys Anti-TPO

REF 06368590 190

For USA: CONTENT

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Polyclonal anti-TPO antibody (sheep) labeled with ruthenium complex 1.0 mg/L
- R2 Biotinylated TPO (recombinant) 0.15 mg/L



Rx only

002



1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов



1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9170 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 48305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2\_dia@roche.com

Кат. номер 06368690190


1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов




1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов



1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов

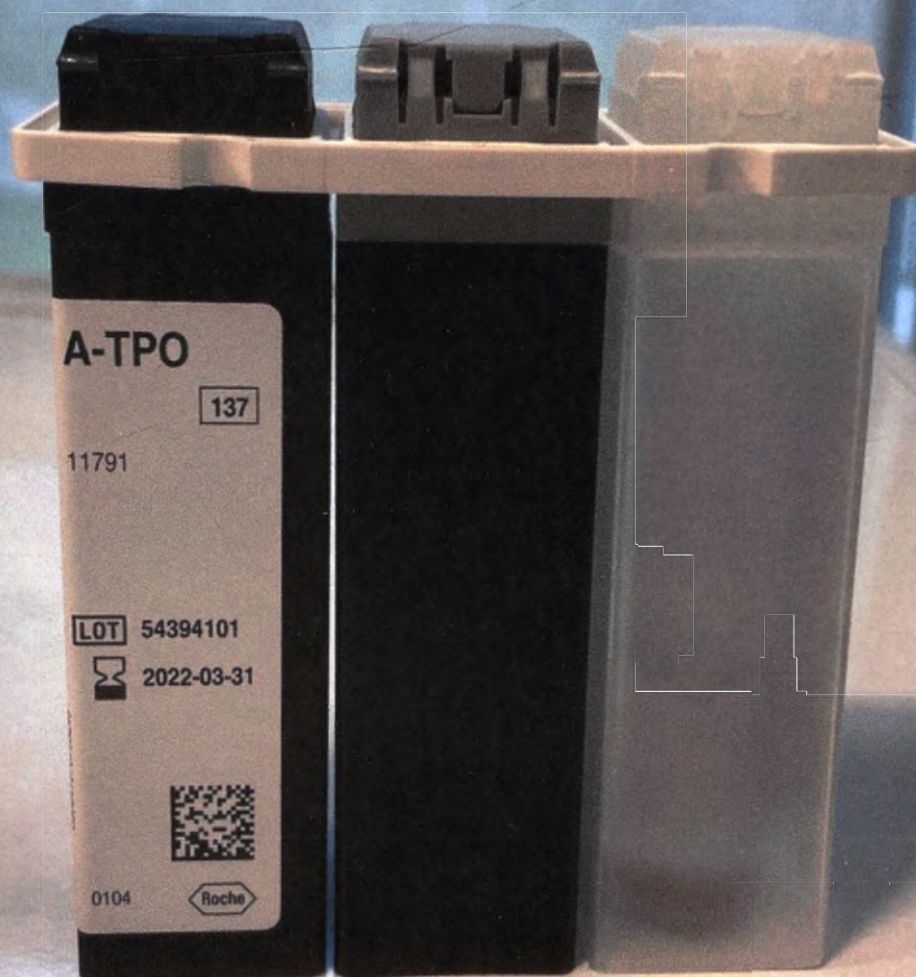

1. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO), вариант исполнения на 100 тестов

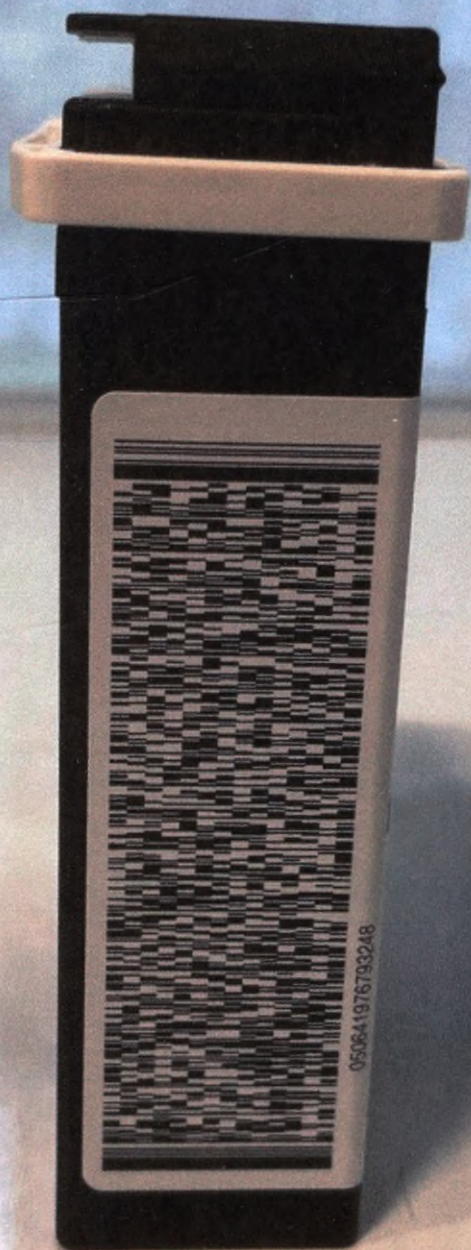

2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)

# Elecsys Anti-TPO

**cobas e analyzers**

H317  
P261,P272,P280  
P313+P333  
P362+P364,P501



**REF** 07026935190

**CONTENT**  300

COBAS, COBAS E and  
ELECSYS are trademarks  
of Roche.

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>R1</b> | 18.8 mL |
| <b>R2</b> | 19.7 mL |
| <b>M</b>  | 13.2 mL |




 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

07020279001(1)  
Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

02

**IVD** **CE**  2-8 °C

 [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)



**cobas**<sup>®</sup>

2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)

# Elecsys Anti-TPO

**REF** 07026935190

For **USA:** **CONTENT**

- |           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R1</b> | Polyclonal anti-TPO antibody (sheep) labeled with ruthenium complex 1.0 mg/L |
| <b>R2</b> | Biotinylated TPO (recombinant) 0.15 mg/L                                     |
| <b>M</b>  | Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL                                |



Rx only


001



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)

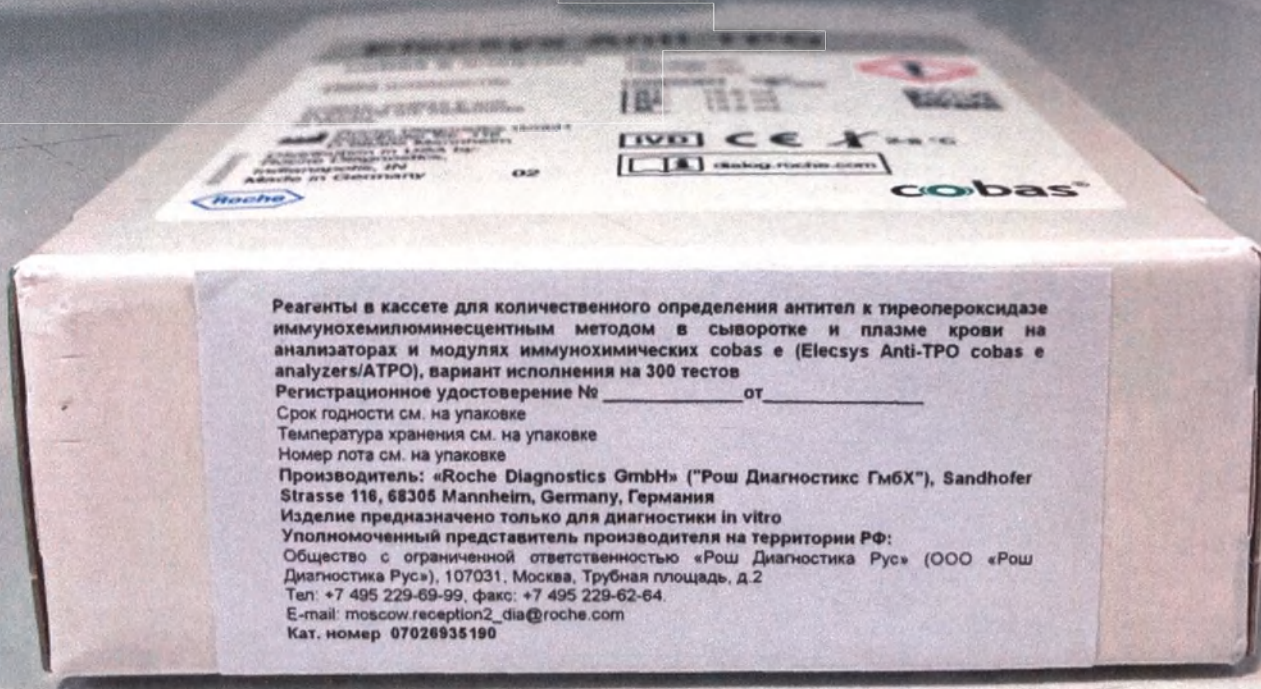

2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)



2. Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO cobas e analyzers/ATPO), вариант исполнения на 300 тестов)





по доверенности  
от 04.02.2021

Всего пронумеровано  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
20 листа (ов)