

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭНДОМАРКЕТ ДЕЗ»

Деннер А.А.



20 24

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ЭНДОСКОПОВ
MEDINOVA®**

Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов
«ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®, в составе
Блок установки
(вид спереди)




**Блок установки
(вид сзади)**




Блок установки (вид сверху)



Блок установки
(панель управления)

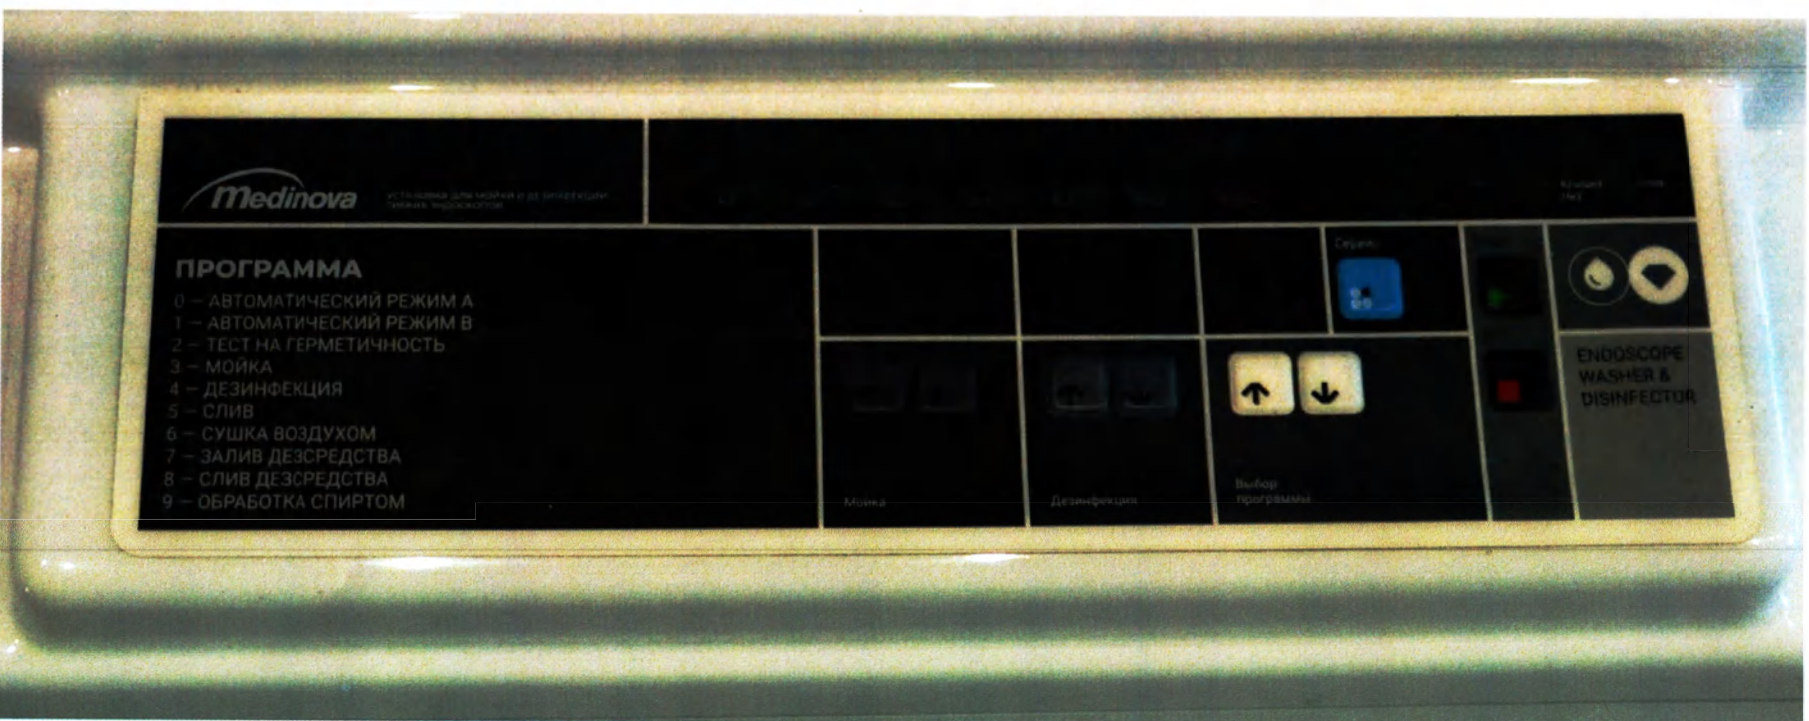


Адаптер для подключения эндоскопа к установке

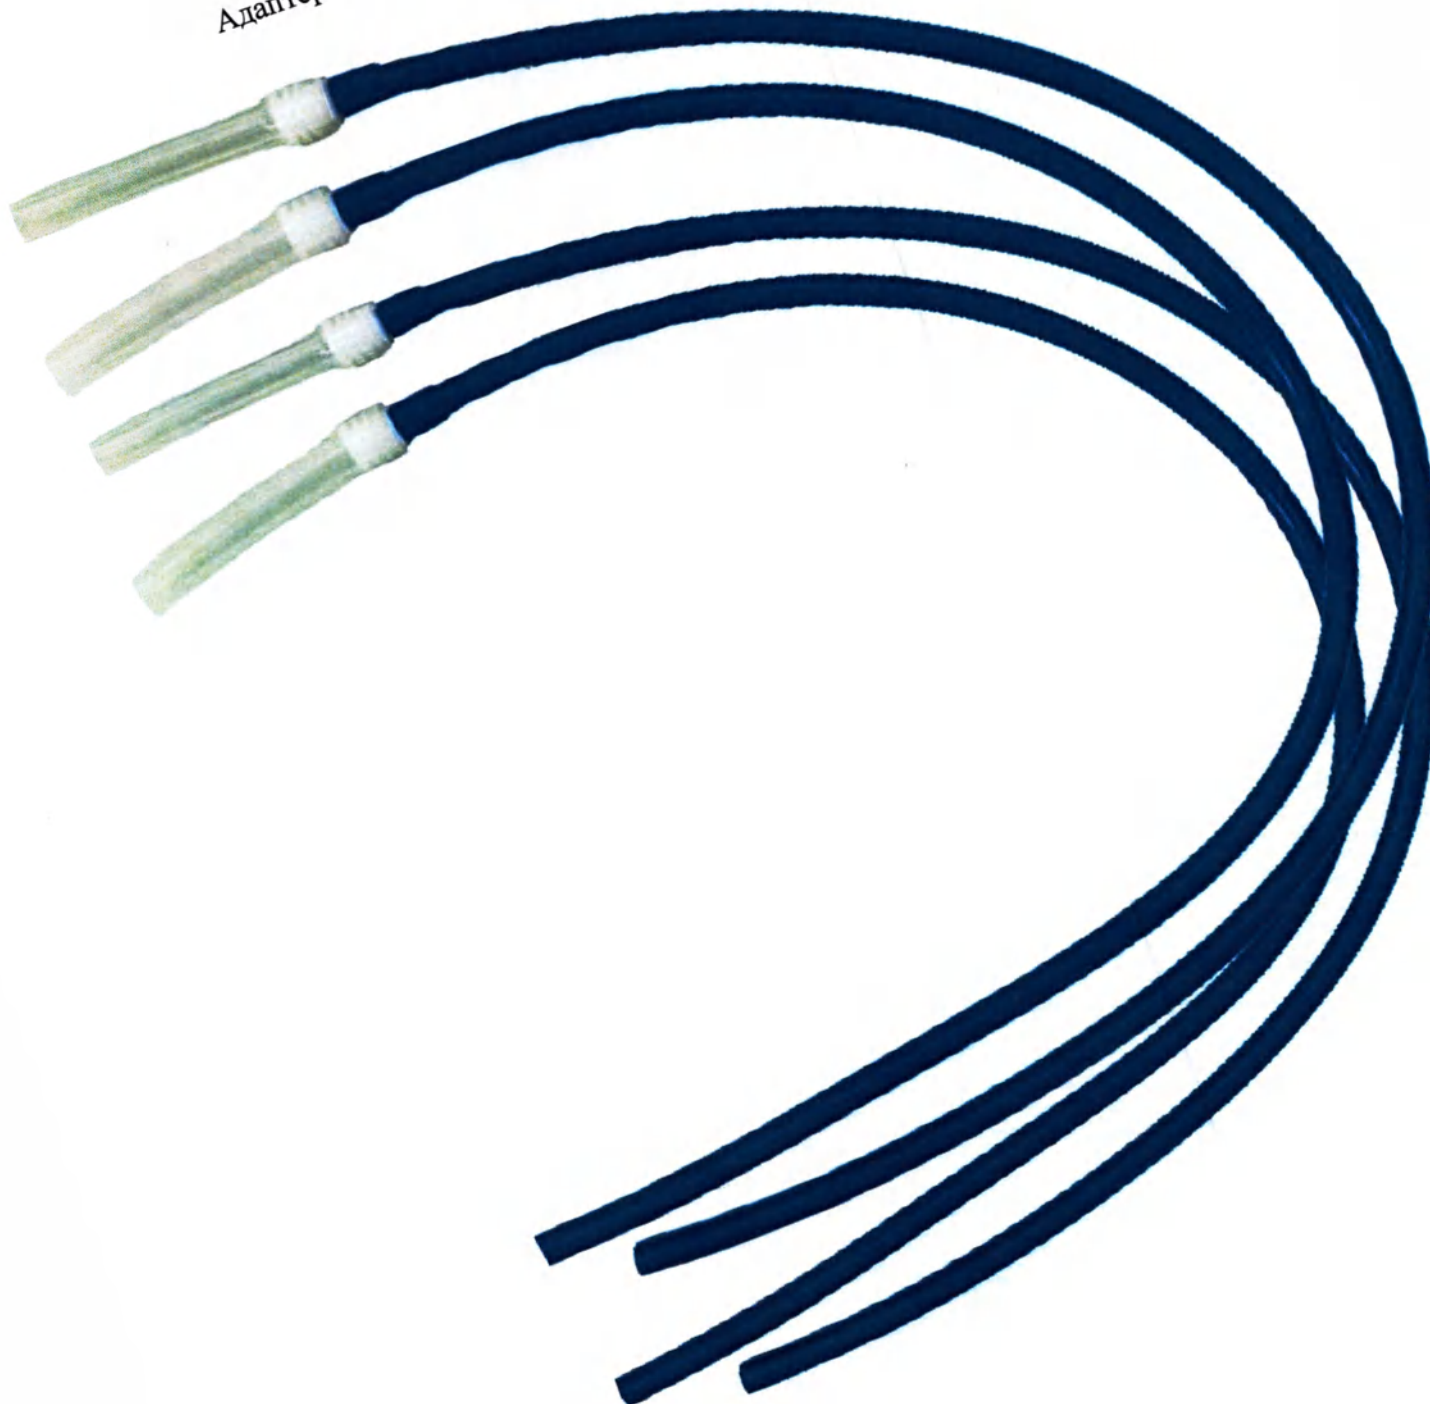

Страница 6 из 48

Соединитель тройник Y – образный

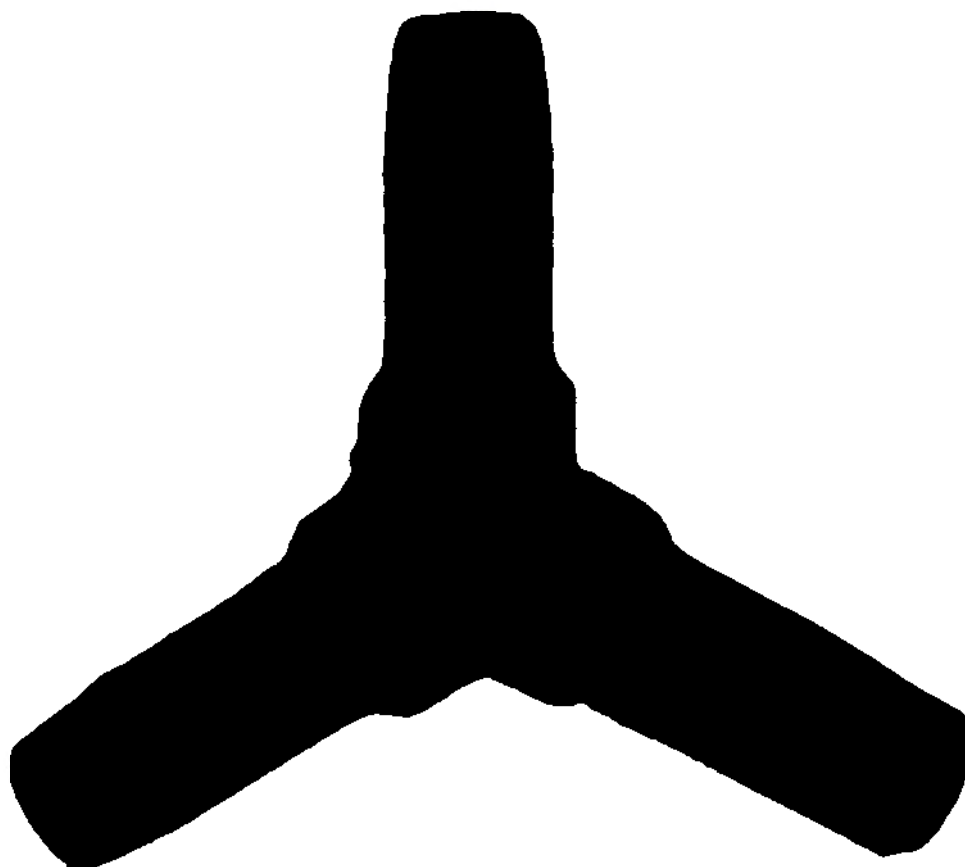


Корзина для мелких деталей



Шланг для водоподведения с адаптером



Принтер для документирования процесса обработки

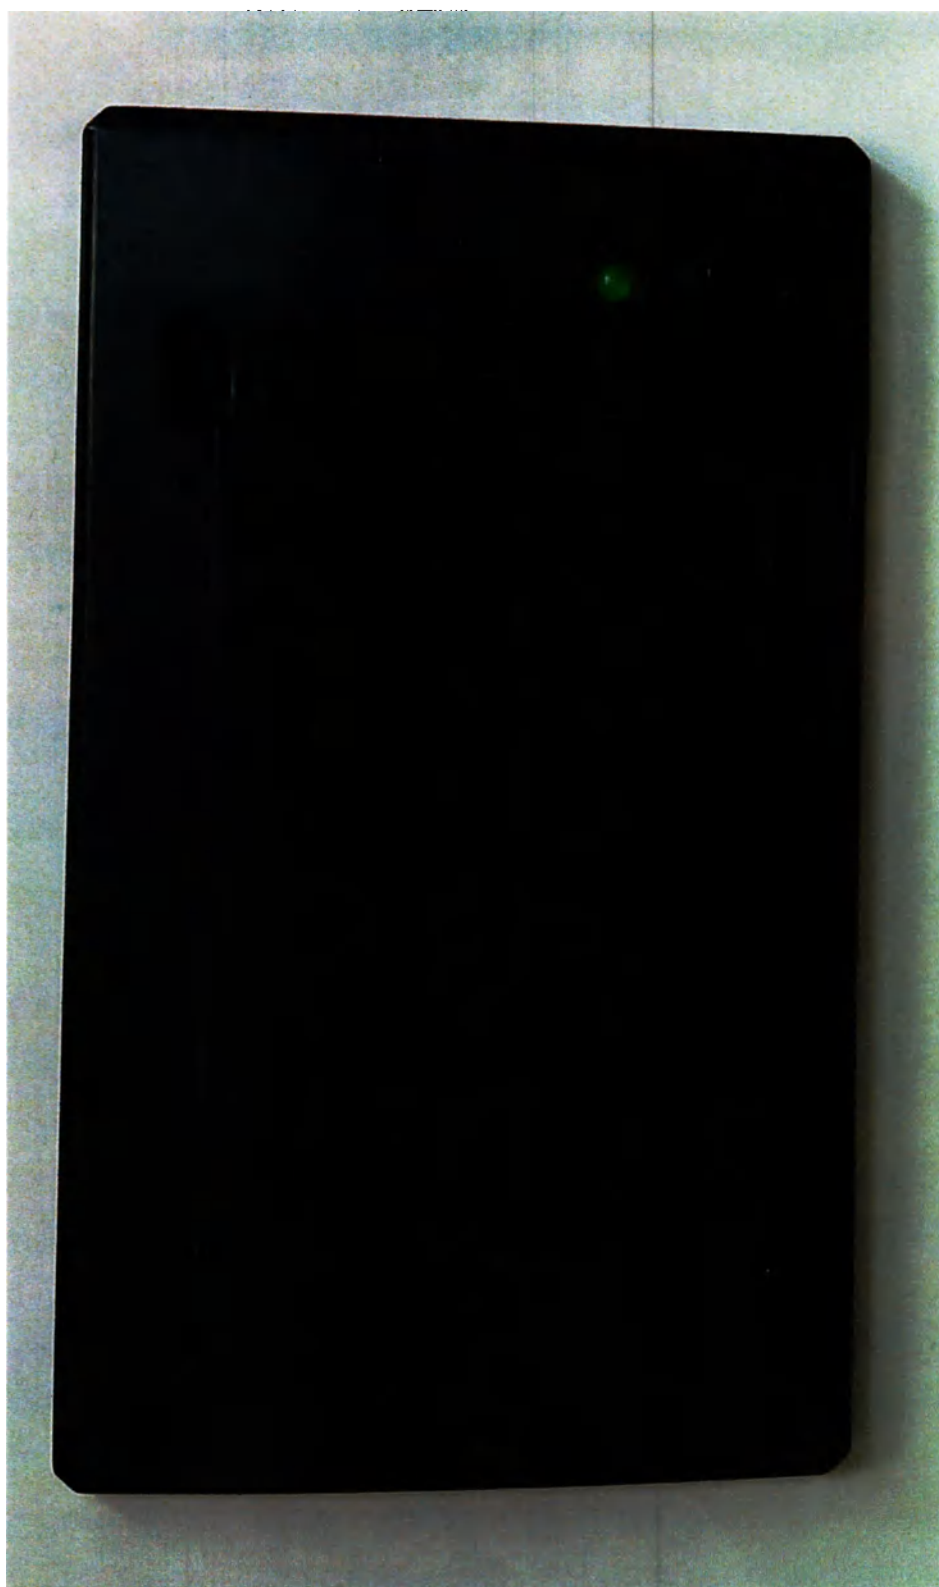

Комплект для водоподготовки
Редуктор



Манометр




Подводка гибкая для воды



Тройник



Трехступенчатая система магистральных фильтров

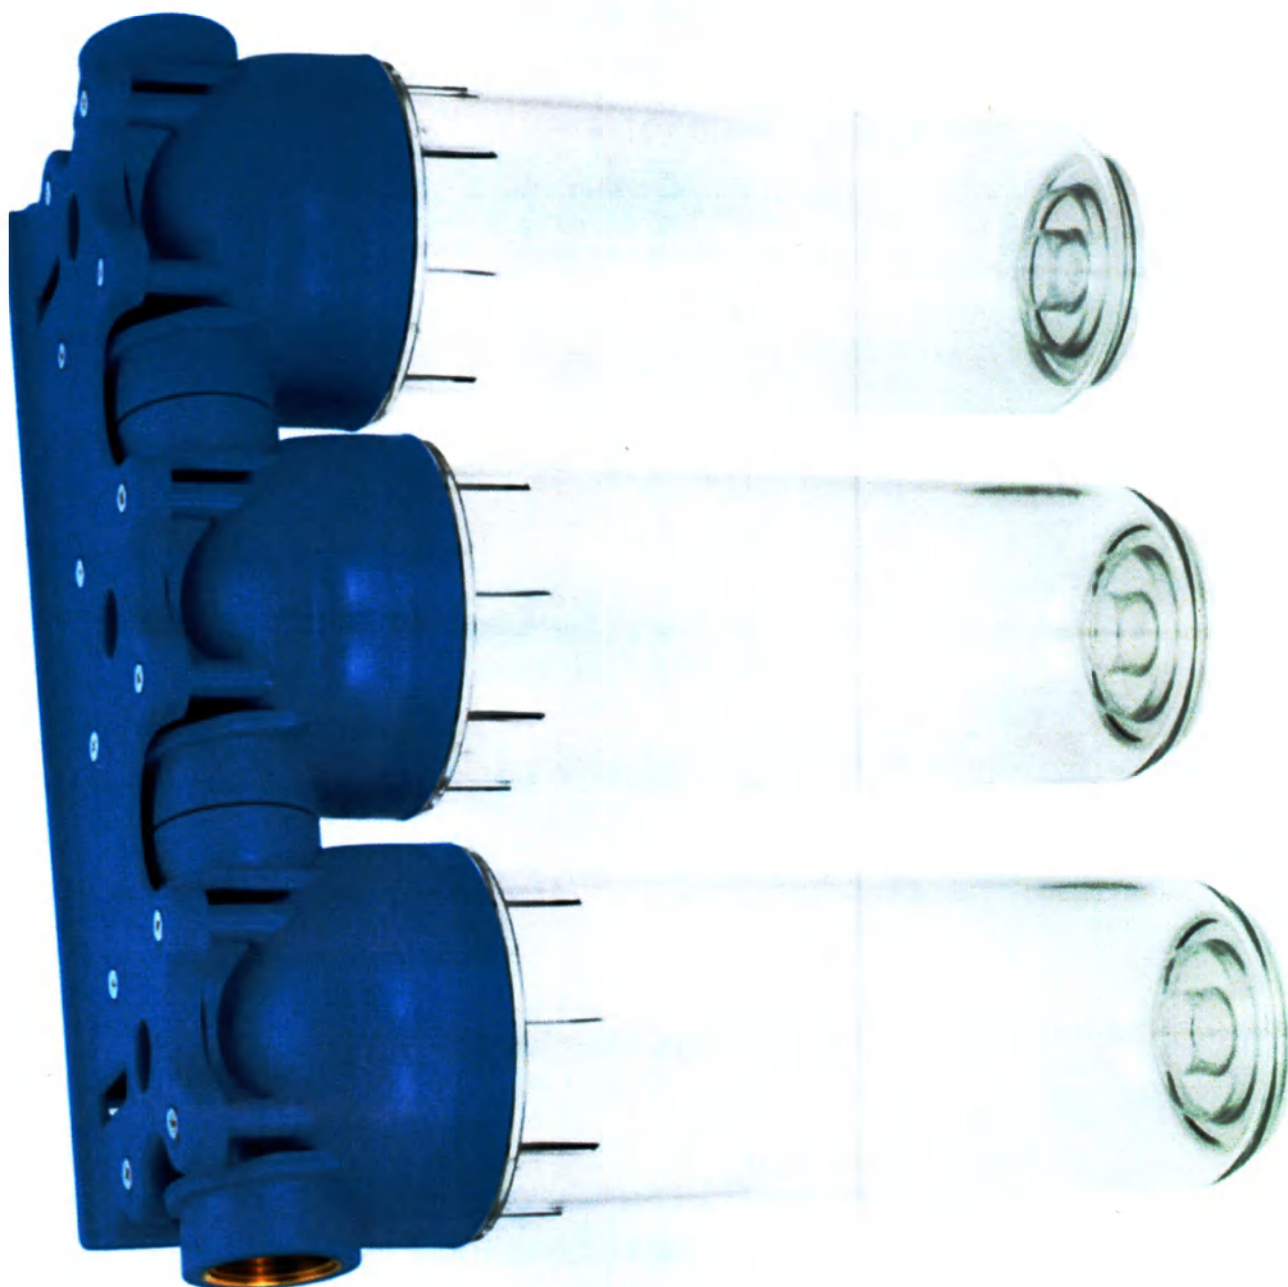

**Сменный картридж, проточного типа Slim Line10" (SL10) 0,2 мкм
(при необходимости)**



**Сменный картридж, проточного типа Slim Line10" (SL10) 1 мкм
(при необходимости)**




**Сменный картридж, проточного типа Slim Line10" (SL10) 5 мкм.-
(при необходимости)**



Шланг для водоотведения с адаптером



Адаптер для проверки герметичности в сборе

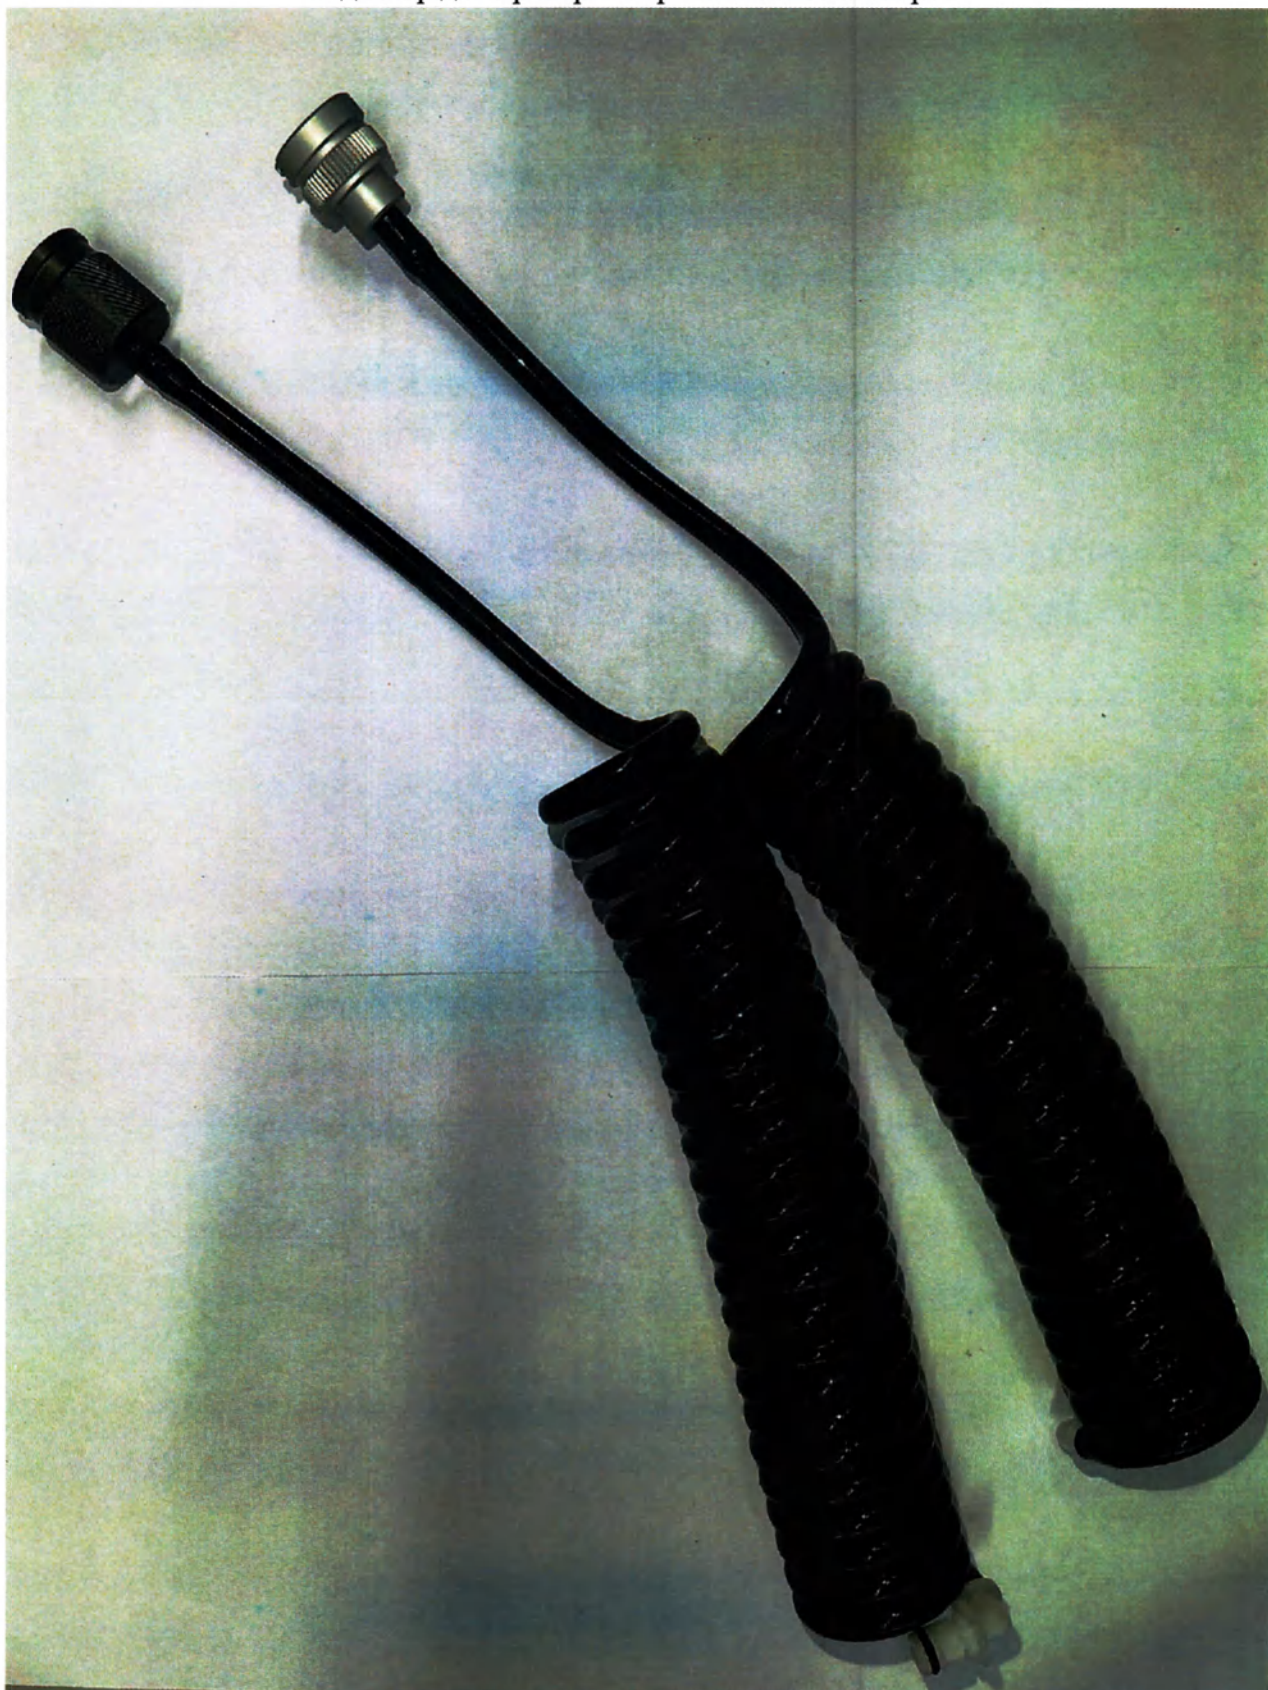

Плавкий предохранитель 250В/10А, размером 6 х30 мм – 2 шт.



Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов

«ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®, в составе

Блок установки

(вид спереди)




**Блок установки
(вид сзади)**




**Блок установки
(вид сверху)**




Блок установки
(панель управления)

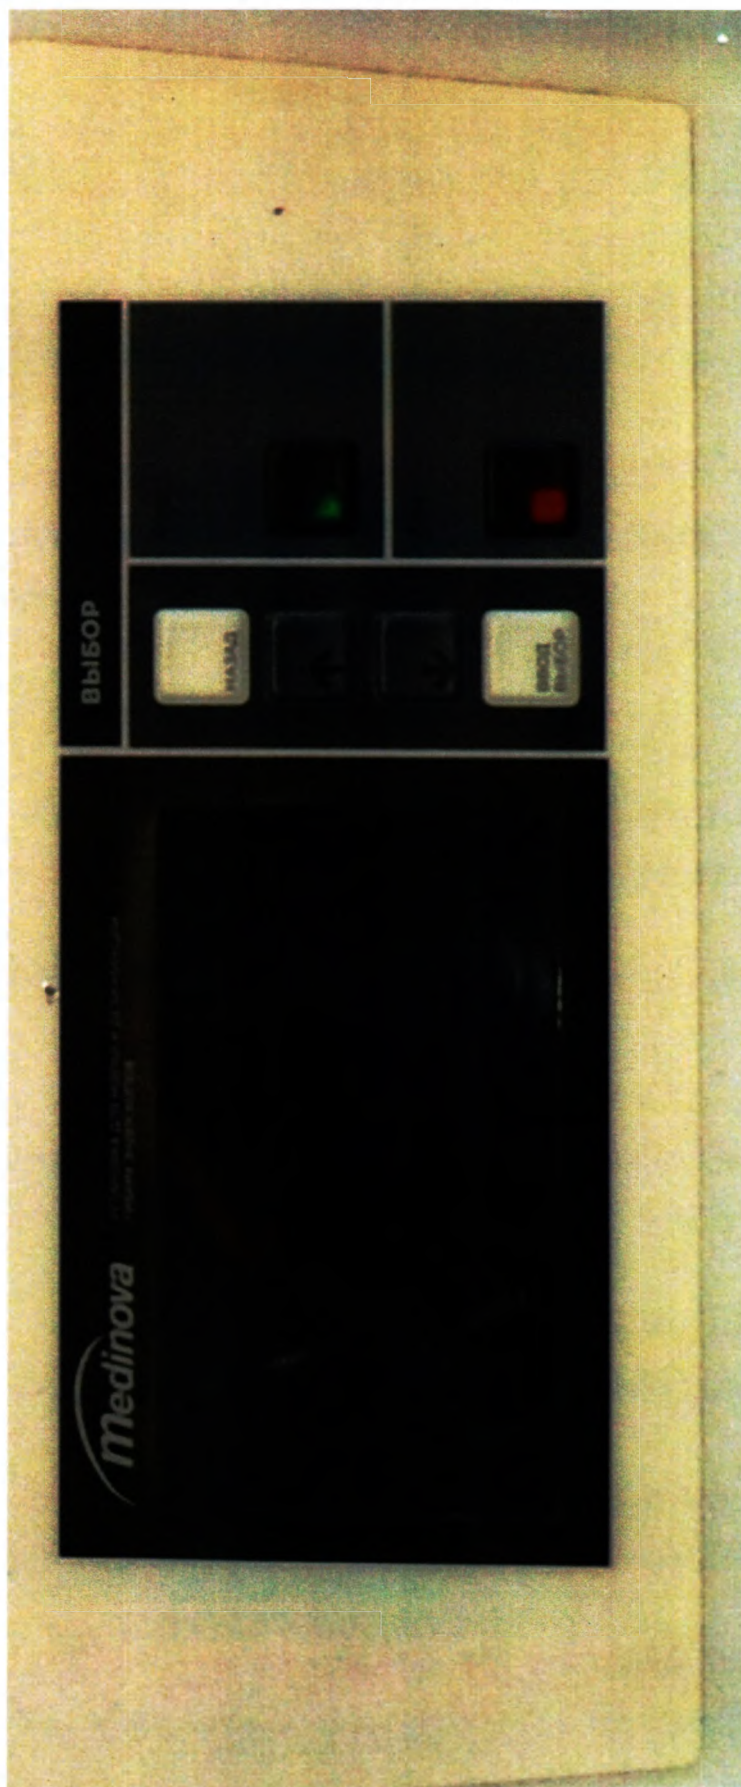

Адаптер для подключения эндоскопа к установке

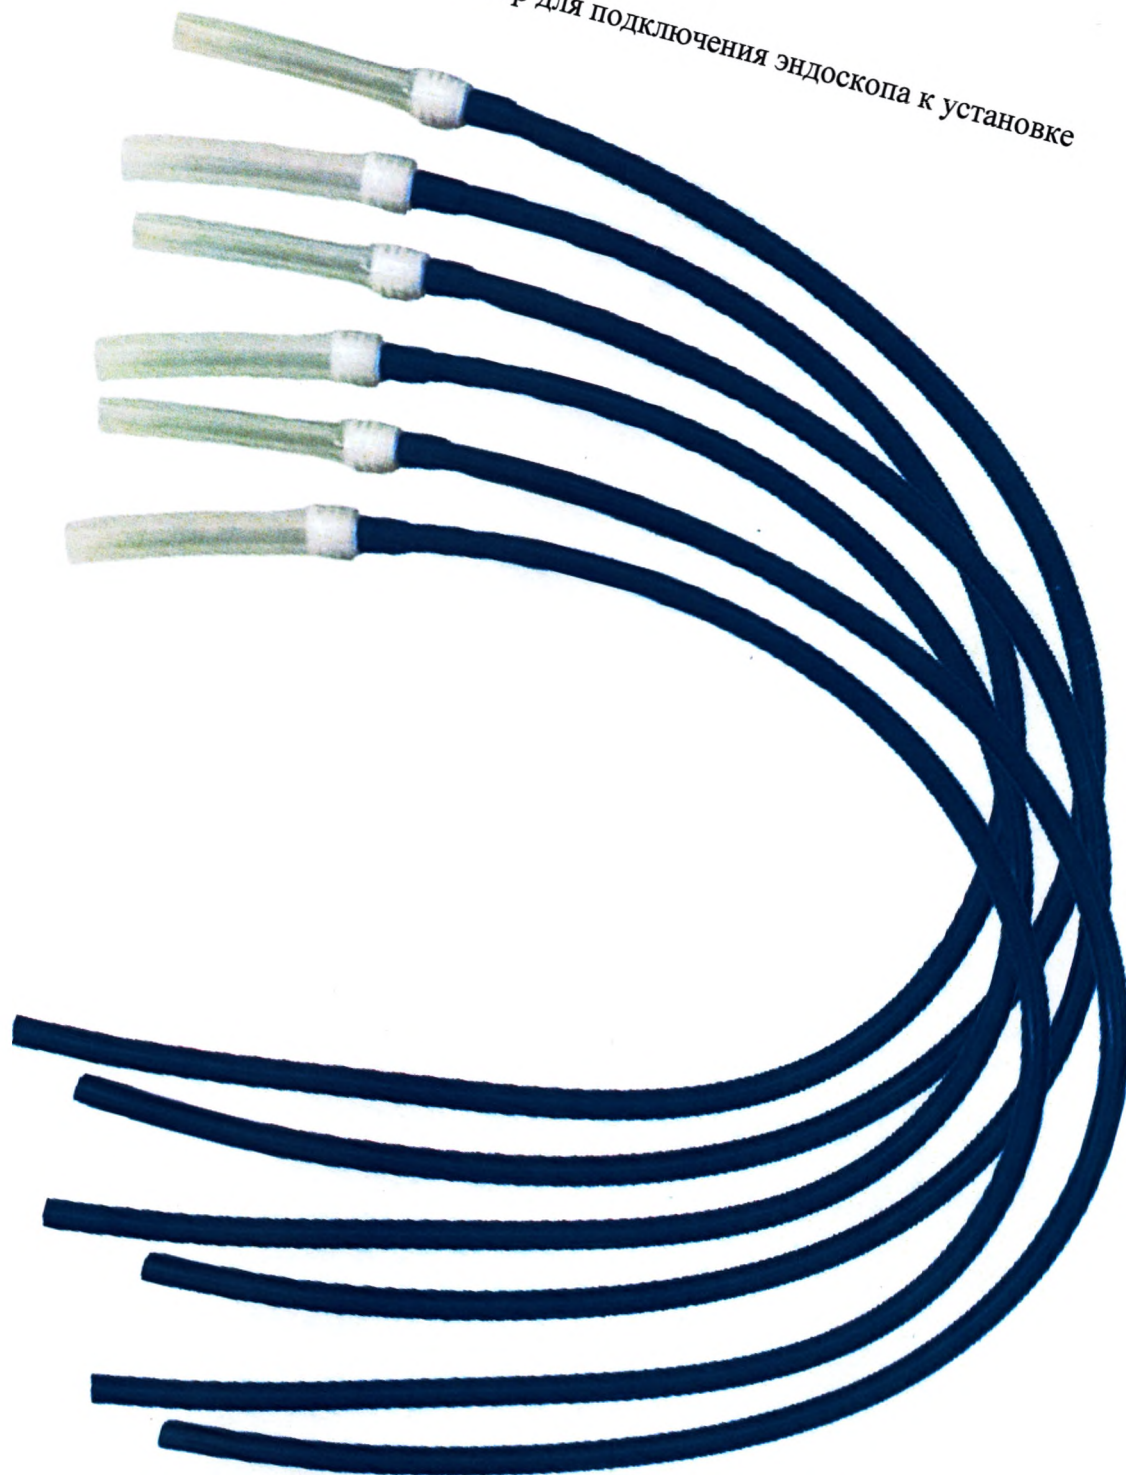


Соединитель тройник Y – образный

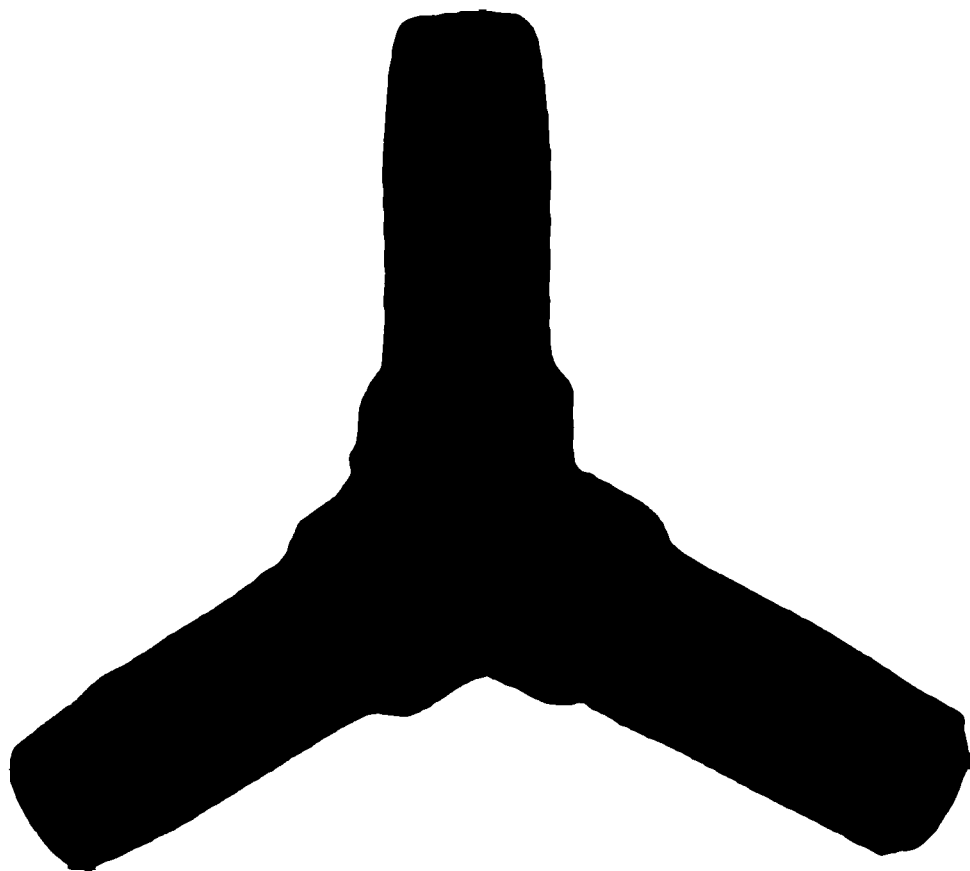

Корзина для мелких деталей




Воронка

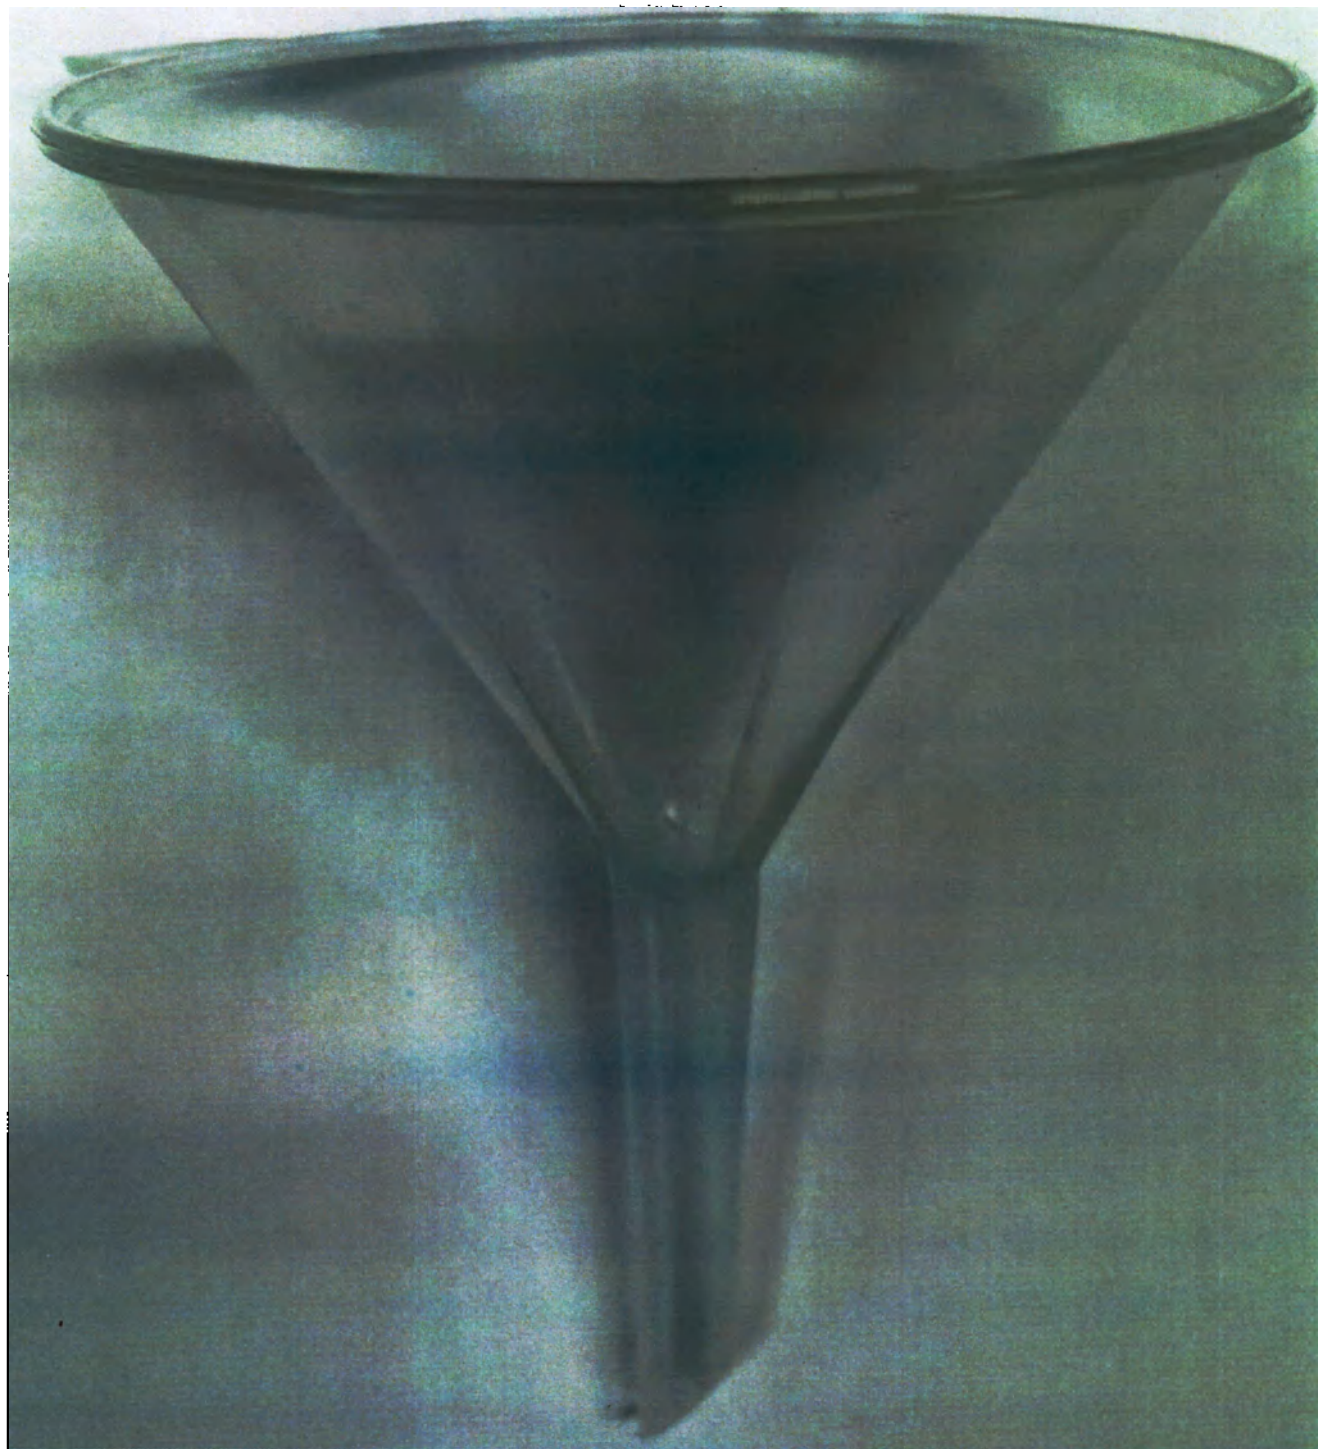

Шланг для водоподведения с адаптером



Принтер для документирования процесса обработки

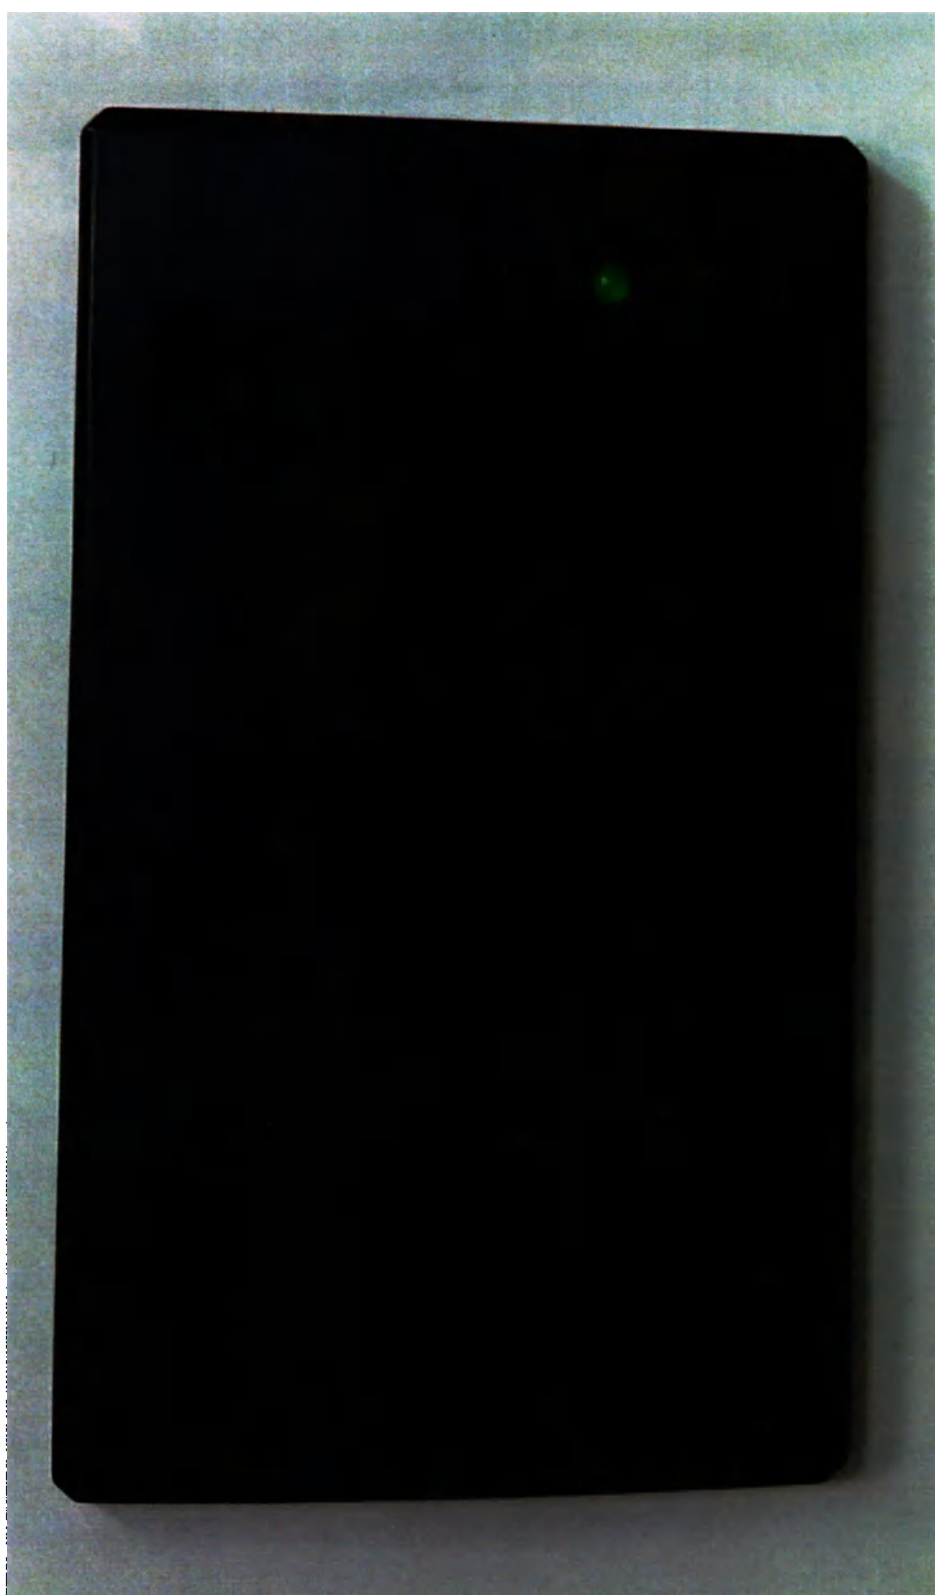

Комплект для водоподготовки
Редуктор




Манометр




Подводка гибкая для воды



Тройник

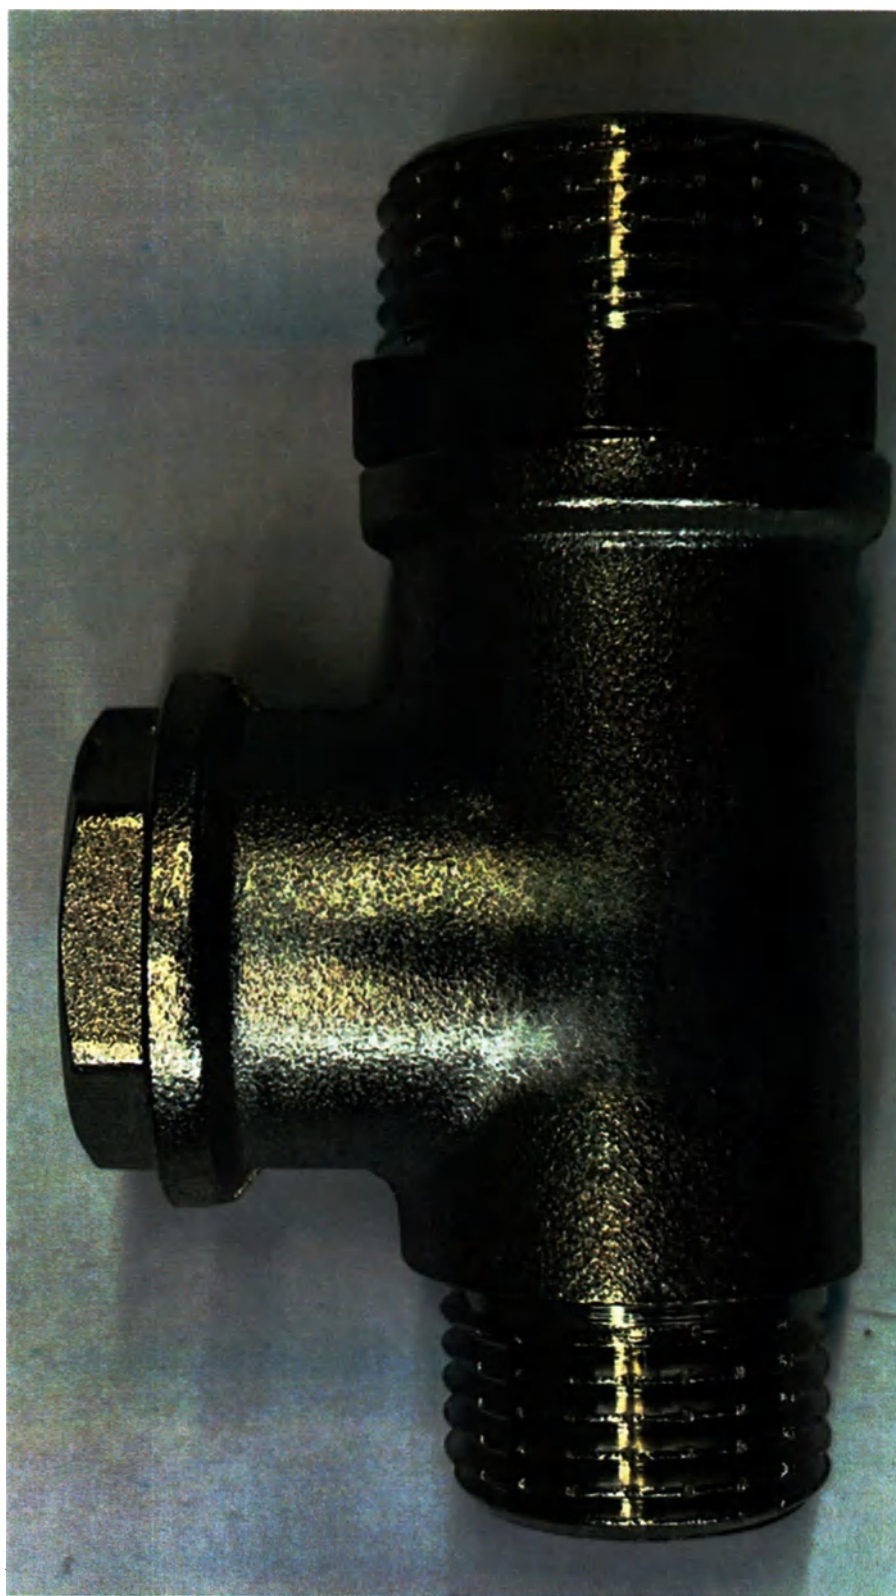

Трехступенчатая система магистральных фильтров

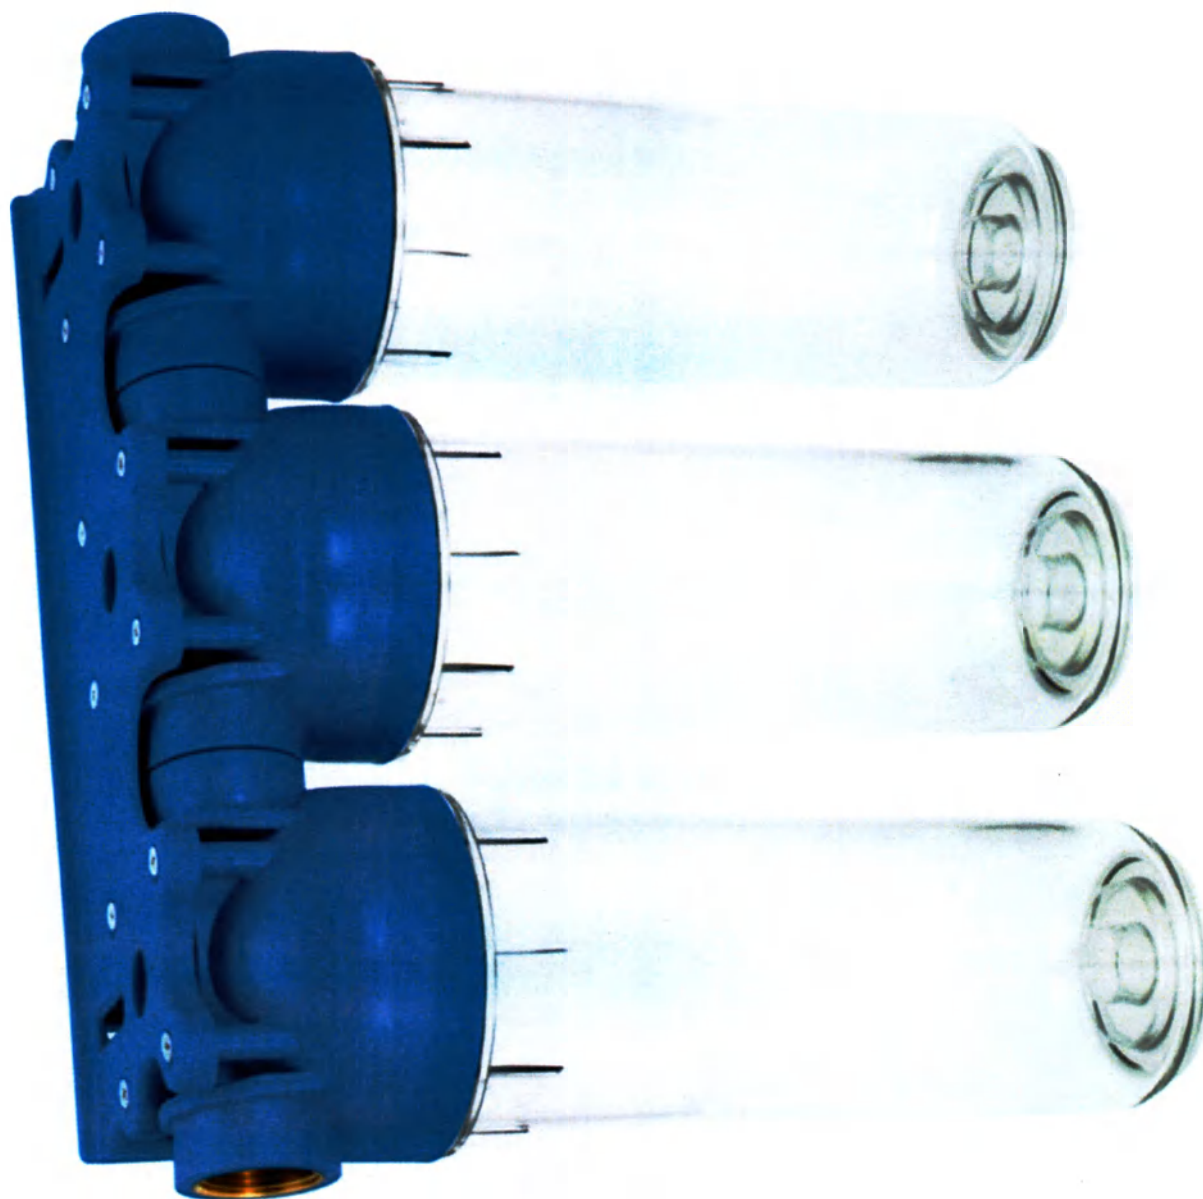

**Сменный картридж, проточного типа Slim Line10" (SL10) 0,2 мкм
(при необходимости)**



**Сменный картридж, проточного типа Slim Line10" (SL10) 1 мкм
(при необходимости)**



**Сменный картридж, проточного типа Slim Line10" (SL10) 5 мкм.-
(при необходимости)**



Шланг для водоотведения с адаптером



Адаптер для проверки герметичности в сборе



Комплект продувочный для сушки



Плавкий предохранитель 250В/6,3А, размером 5х20 мм. – 2 шт



Проект маркировки
«Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®»

Назначение	Автоматическая мойка и дезинфекция высшего уровня гибких медицинских эндоскопов	
Наименование, вариант исполнения	Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®	РУ № _____ / _____ от _____ года
Частота электрической сети	220 – 230 В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	0,75 кВт	
Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 40°C Влажность: от 30% до 85% Атмосферное давление: от 80 до 106 кПа.	
Условия транспортирования и хранения	Температура: от -20°C до 70°C Влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа.	
Вес нетто, кг	58±5%	
	«МЕДИПИЯ Ко., Лтд.» 101-1101, 1102, Пучхон технопарк СангВонг 3, 397, 397, Сончхон-ро, Олсонг-гу, Пучхон-си, Кеши-до, Республика Корея Тел.: +82-32-624-4288, E-mail: medipia@e-medipia.com http://www.endoclean-medipia.com	
	XX.XX.XXXX	
	XX-XXXX-XX	
Уполномоченный представитель в РФ	ООО «ЭНДОМАРКЕТ ДЕЗ» Адрес: 443080, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВПР-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1А, КВ. 114. Тел.: 88005505604, E-mail: info@endomarketdez.ru	
	Правила использования и меры предосторожности: перед использованием ознакомиться с Руководством по эксплуатации	
	 8800037300003	Произведено в Республике Корея

Пример нанесения маркировки
«Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®»

Назначение	Автоматическая мойка и дезинфекция высокого уровня гибких медицинских эндоскопов	
Наименование, вариант исполнения	Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®	РУ № _____ от _____ года
Частота электрической сети	220 – 230 В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	0,75 кВт	
Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 40°C, Влажность: от 30% до 85% Атмосферное давление: от 80 до 106 кПа	
Условия транспортирования и хранения	Температура: от -20°C до 70°C, Влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа	
Вес нетто, кг.	58 ±5%	
	«МЕДИПИЯ Ко., Лтд.» 101-1101, 1102, Пучхон технопарк Ссангйонг 3, 397, 397, Сонхон-ро, Ойеонг-гу, Пучхон-си, Кенгх-до, Республика Корея Тел.: +82 32 624-4288, E-mail: medipia@e-medipia.com http://www.endoclean-medipia.com	
	05.01.2023	
	EN-2301-22	
Уполномоченный представитель в РФ	ООО «ЭНДОМАРКЕТ ДЕЗ» Адрес: 443080, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Центральная, д. 1А, кв. 114. Тел.: +7 (800) 550-56-04, E-mail: info@endomarketdez.ru.	
	Правила использования и меры предосторожности: перед использованием ознакомиться с Руководством по эксплуатации.	
	8800037300003 Произведено в Республике Корея	


Проект маркировки
«Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®»

Назначение	Автоматическая мойка и дезинфекция высокого уровня гибких медицинских эндоскопов	
Наименование, вариант исполнения	Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®	РУ № _____ / _____ от _____ года
Частота электрической сети	220 – 230 В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	2,0 кВт	
Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 40°C Влажность: от 30% до 85% Атмосферное давление: от 80 до 106 кПа.	
Условия транспортирования и хранения	Температура: от -20°C до 70°C Влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа.	
Вес нетто, кг	82±5%	
	«МЕДИПИЯ Ко., Лтд.» 101-1101, 1102, Пучхон технопарк Сонгдонг 3, 397, 397, Сонгхон-ро, Ойсонг-гу, Пучхон-си, Кёнги-до, Республика Корея Тел.: +82-32-624-4288, E-mail: medipia@e-medipia.com http://www.endoclean-medipia.com	
	XX.XX.XXXX	
	XX-XX-XXXX-XX	
Уполномоченный представитель в РФ	ООО «ЭНДОМАРКЕТ ДЕЗ» Адрес: 443080, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВПР-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г. САМАРА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1А, КВ. 114. Тел.: 88005505604, E-mail: info@endomarketdez.ru	
	Правила использования и меры предосторожности: перед использованием ознакомиться с Руководством по эксплуатации	
	 8800037300003	Произведено в Республике Корея


Пример нанесения маркировки
«Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®»

Назначение	Автоматическая мойка и дезинфекция высокого уровня гибких медицинских эндоскопов	
Наименование, вариант исполнения	Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®	Р/У № _____ / _____ от _____ года
Частота электрической сети	220 – 230 В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	2,0 кВт	
Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 40°C, Влажность: от 30% до 85% Атмосферное давление: от 80 до 106 кПа	
Условия транспортирования и хранения	Температура: от -20°C до 70°C, Влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа	
Вес нетто, кг.	82 ±5%	
	«МЕДИПИА Ко., Лтд.» 101-1101, 1102, Пучон технопарк Ссангйонг 3, 397, 397, Сончхон-ро, Ойеонг-гу, Пучхон-си, Кенги-до, Республика Корея Тел.: +82-32-624-4288, E-mail: medipia@e-medipia.com http://www.endoclean-medipia.com	
	05.01.2023	
	EN-DU-2301-01	
Уполномоченный представитель в РФ	ООО «ЭНДОМАРКЕТ ДЕЗ» Адрес: 443080, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Центральная, д. 1А, кв. 114. Тел.: +7 (800) 550-56-04, E-mail: info@endomarketdez.ru.	
	Правила использования и меры предосторожности; перед использованием ознакомиться с Руководством по эксплуатации.	
	ИЗДАНИЕ 01.11.2022 г. ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ 8800017300003	Произведено в Республике Корея

Проект транспортной упаковки
«Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®»

Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» MEDINOVA®			
 MEDIPIA Co., Ltd. 101-1101, 1102, Bucheon techno-park Ssangyong 3rd, 397, 397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Отправитель: XXXXXXXX	SN XX-XX-XXXX-XX Получатель: XXXXXXXX		
			

Проект транспортной упаковки
«Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®»

Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 2000» MEDINOVA®			
 MEDIPIA Co., Ltd. 101-1101, 1102, Bucheon techno-park Ssangyong 3rd, 397, 397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Отправитель: XXXXXXXX	SN XX-XX-XXXX-XX Получатель: XXXXXXXX		
			

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью Искра Восток лист(ов)



ООО «ЭНДОМАРКЕТ ДЕЗ»

Деннер А.А.

« 29 »

20 24 г