

Генеральный директор ООО «АЛКОТЕКТОР»



[Handwritten signature]

А.С. Сидоров

«30» 05 2024 года

по доверенности Shenzhen Well Electric Co., Ltd

от 25.07.2022

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

«АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями,


вариант исполнения Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
общего вида состава медицинского изделия,
упаковки и маркировки

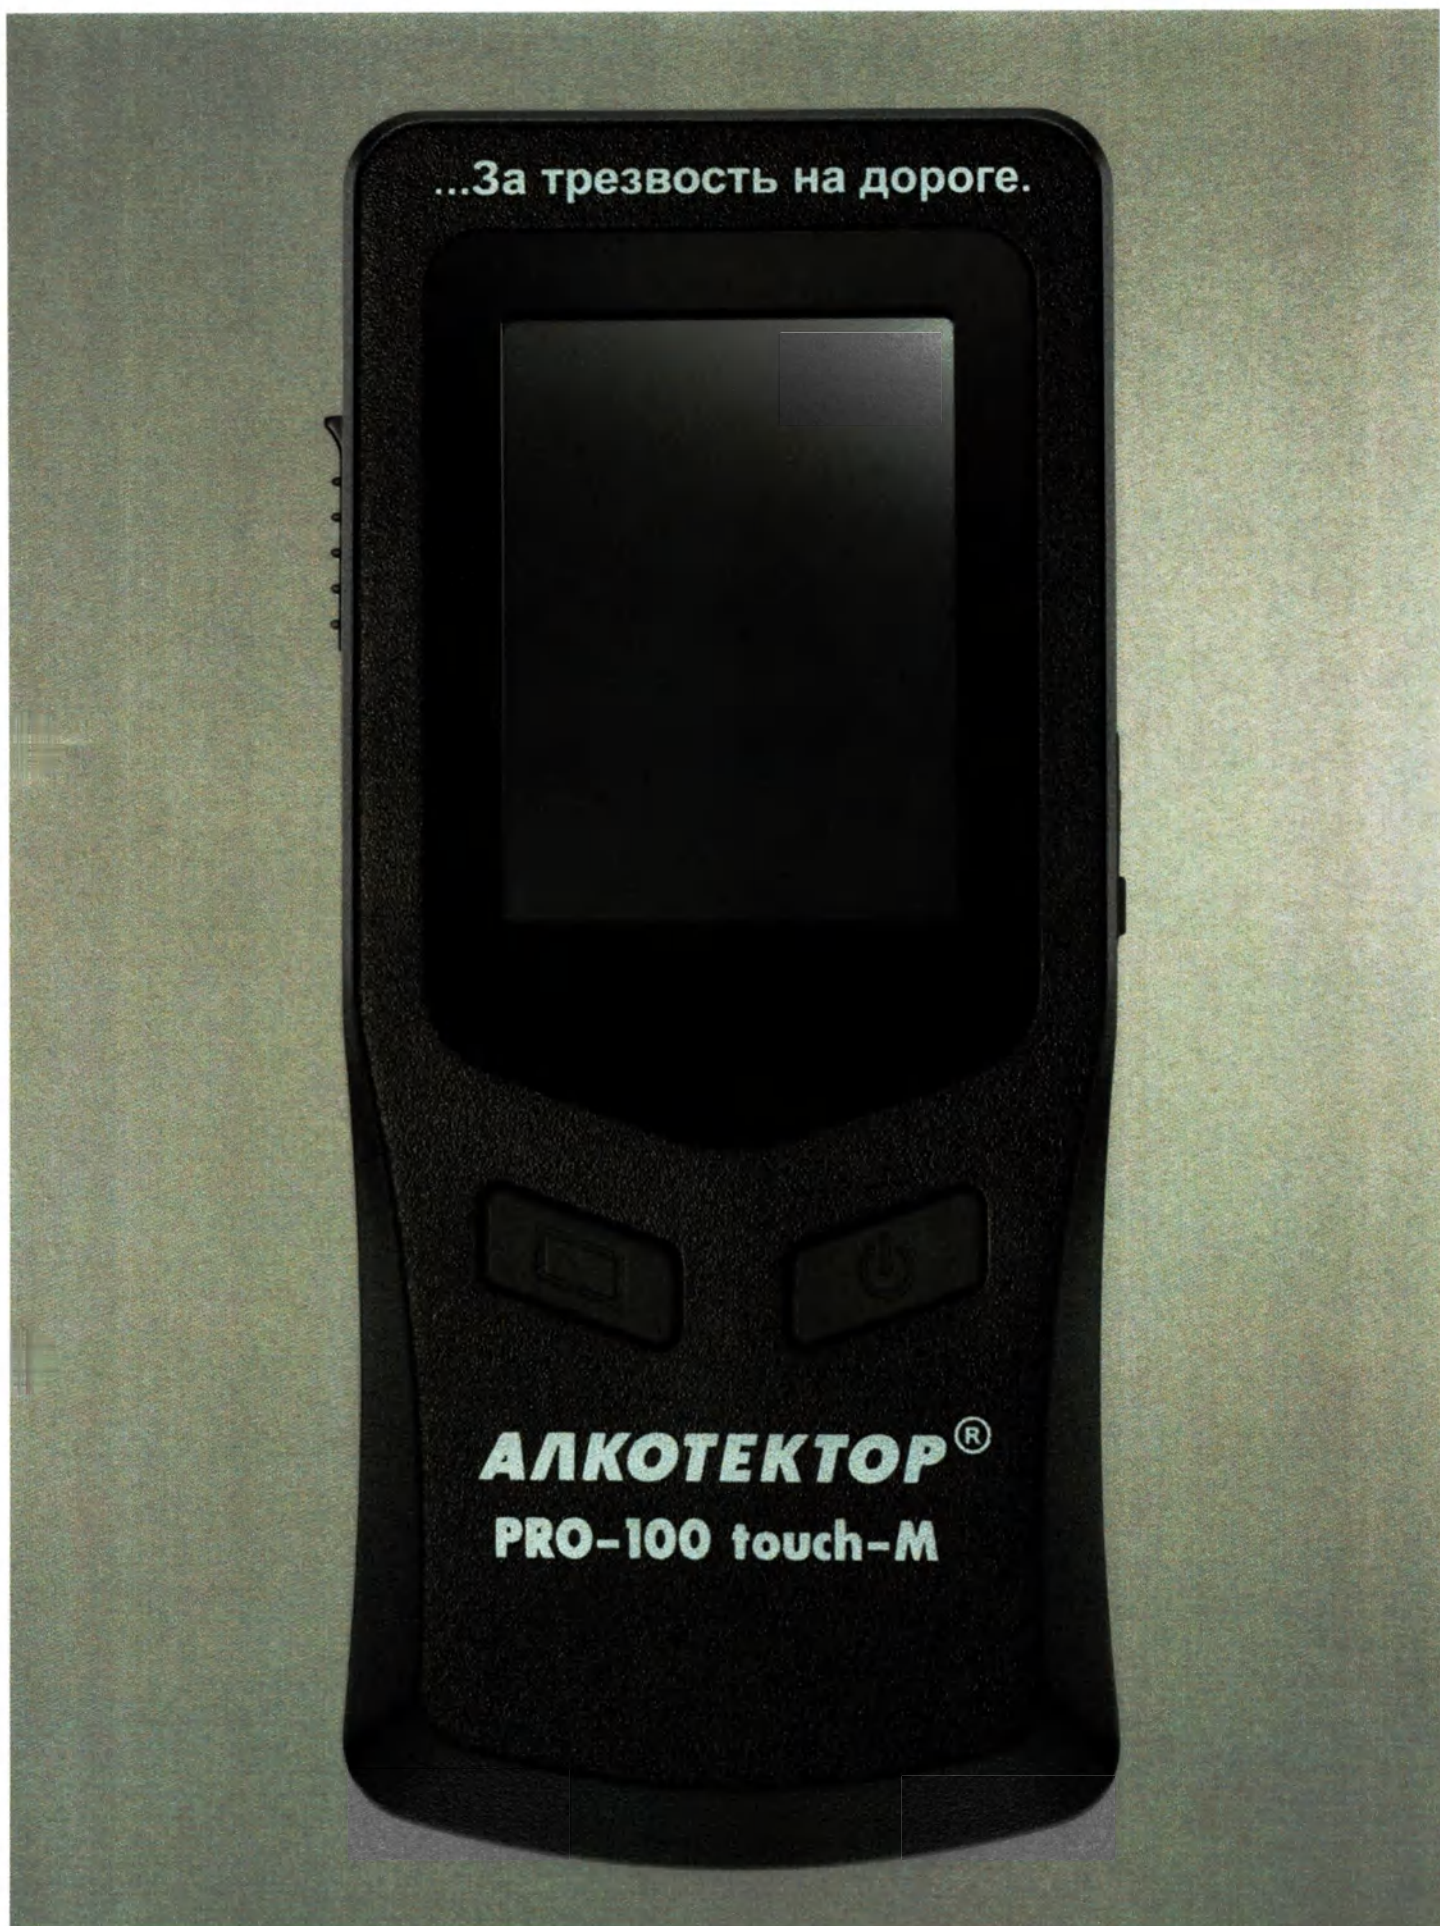

Анализатор (вид спереди)

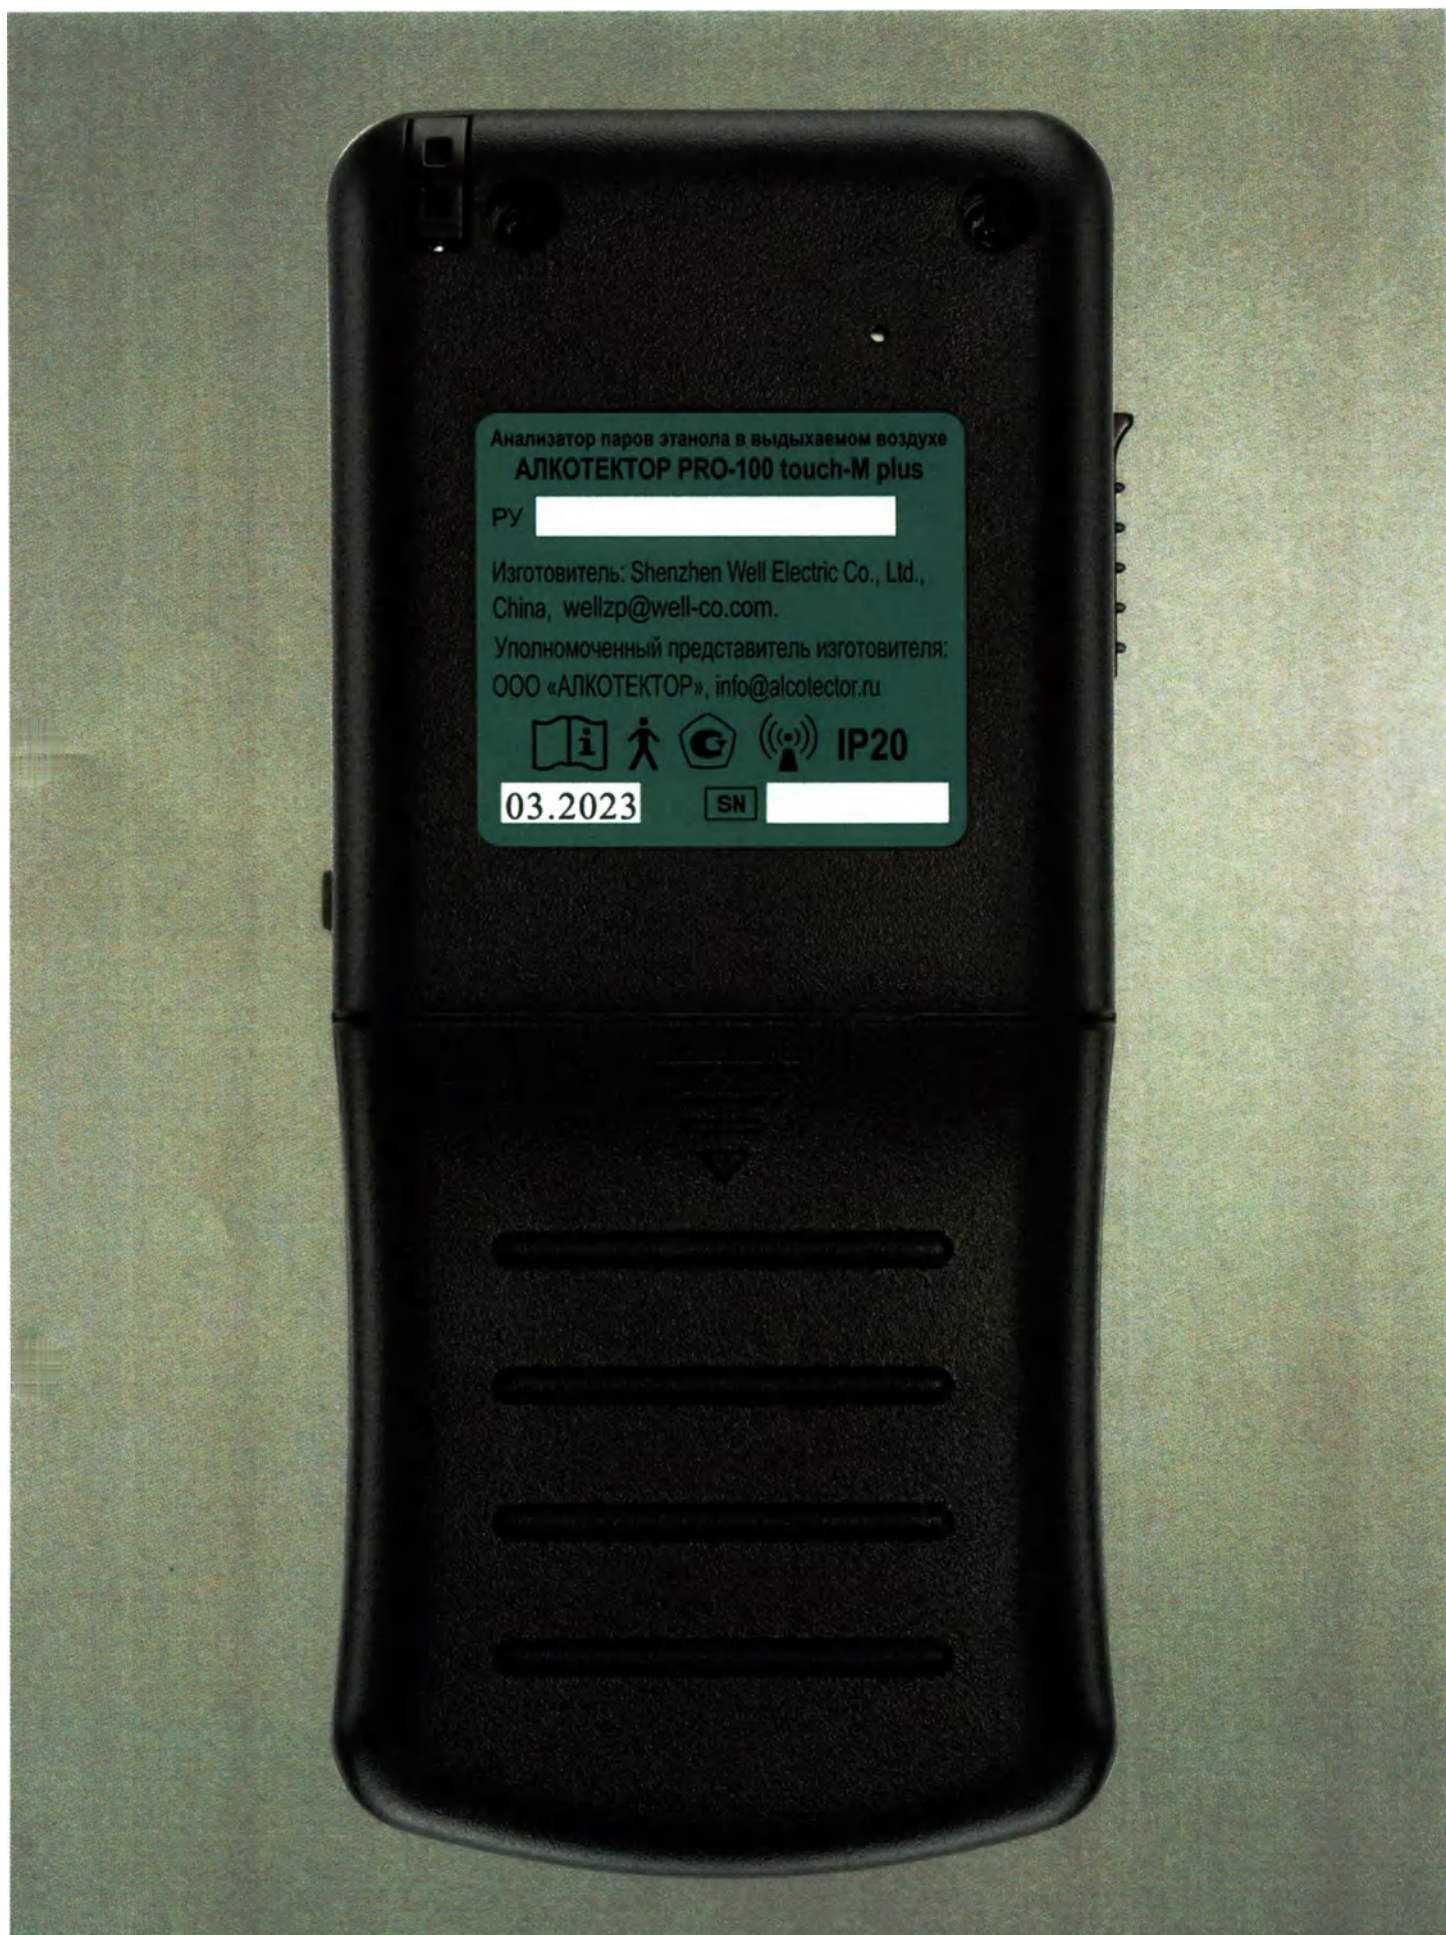

Анализатор (вид сзади)

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

РУ

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd.,
China, wellzp@well-co.com.

Уполномоченный представитель изготовителя:
ООО «АЛКОТЕКТОР», info@alcotector.ru




IP20

SN



Мундштук

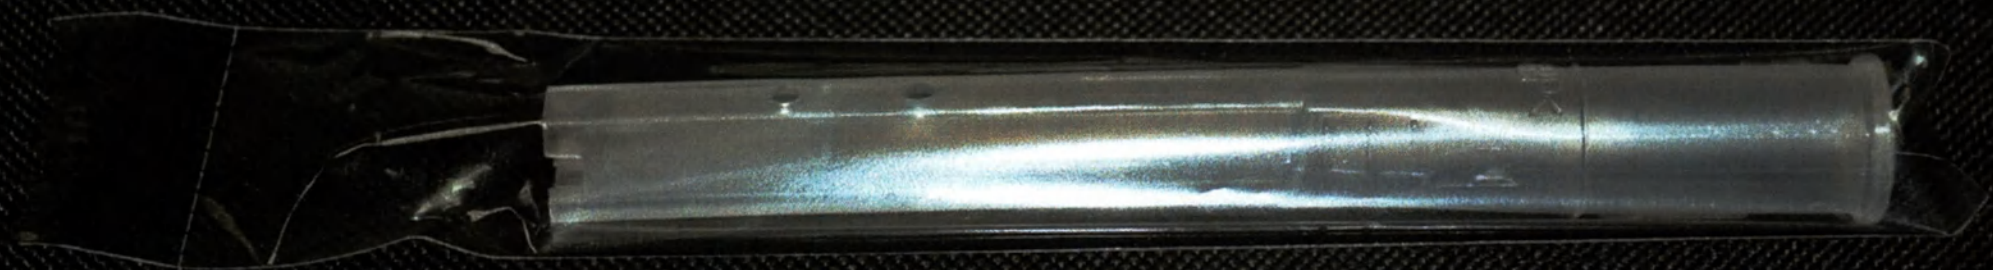

Мундштук в первичной упаковке

Мундштук



Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China

1-3F, Building 101, No. 407, HeDongCun, HengKeng, GuanCheng
Community, GuanHu Street, Longhua District, Shenzhen City,
Guangdong, China

МУНДШТУК **ШТ.**

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus



LOT

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com





Изготовитель:
Shenzhen Well Electric Co., Ltd., Китай

АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА
В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ


«АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M»

с принадлежностями

Уполномоченный представитель изготовителя в России:
ООО «АЛКОТЕКТОР», www.alcotector.ru



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
общего вида принадлежностей медицинского изделия,
упаковки и маркировки

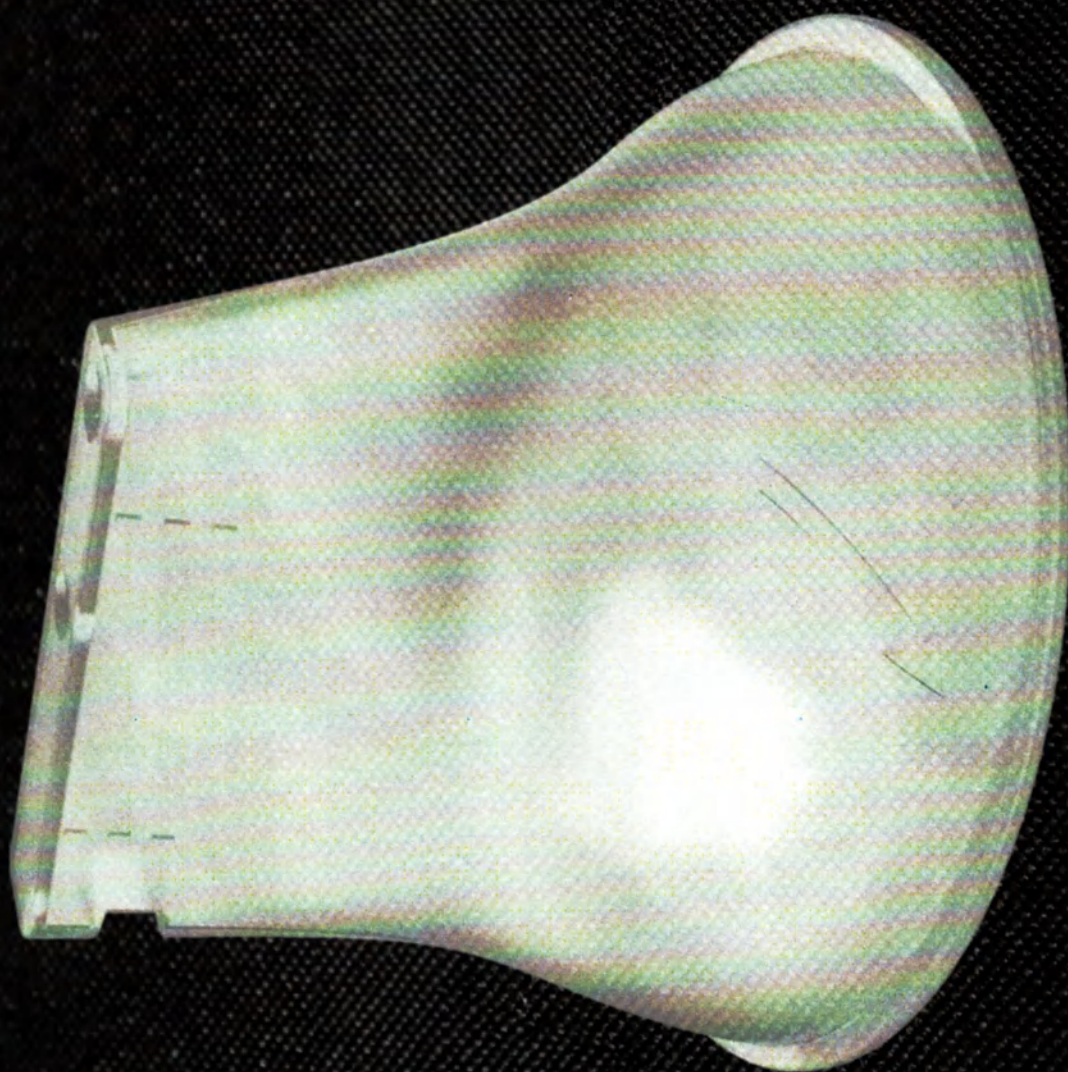

Мундштук -воронка



Мундштук-воронка в упаковке

МУНДШТУК-ВОРОНКА

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K,



для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
«АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К»,
«Юпитер-П»,




LOT

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015).

исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»

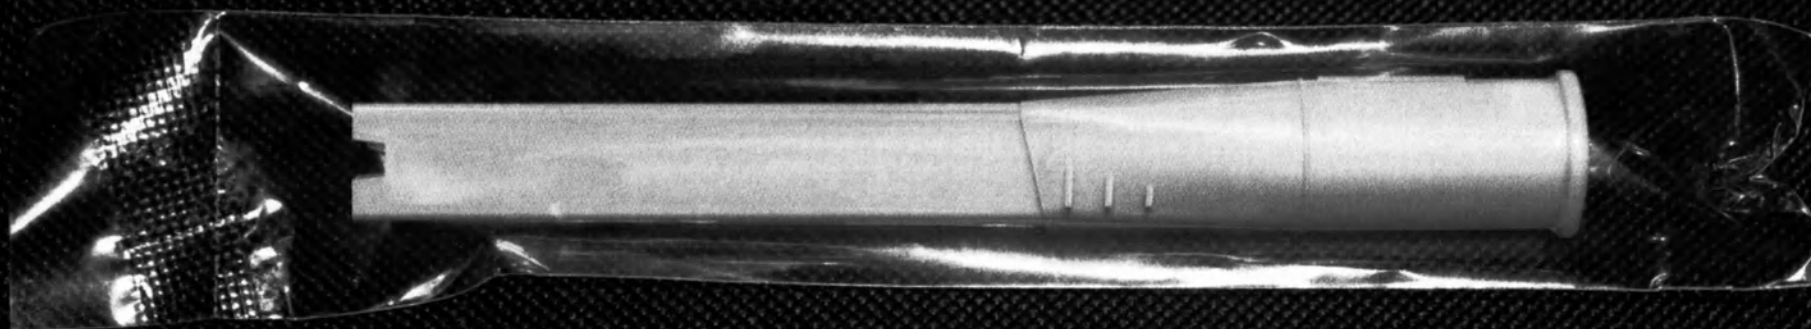

Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»
в первичной упаковке

Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015)



 ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н.

Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015)
ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н.



Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»



ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н.

Сделано в России



LOT

ШТ.



Кабель USB



Кабель USB

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K,

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus



Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com

03.2023

LOT 202303

Кабель USB в упаковке

Кабель USB

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K,

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus




Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



LOT



Термопринтер (вид спереди)

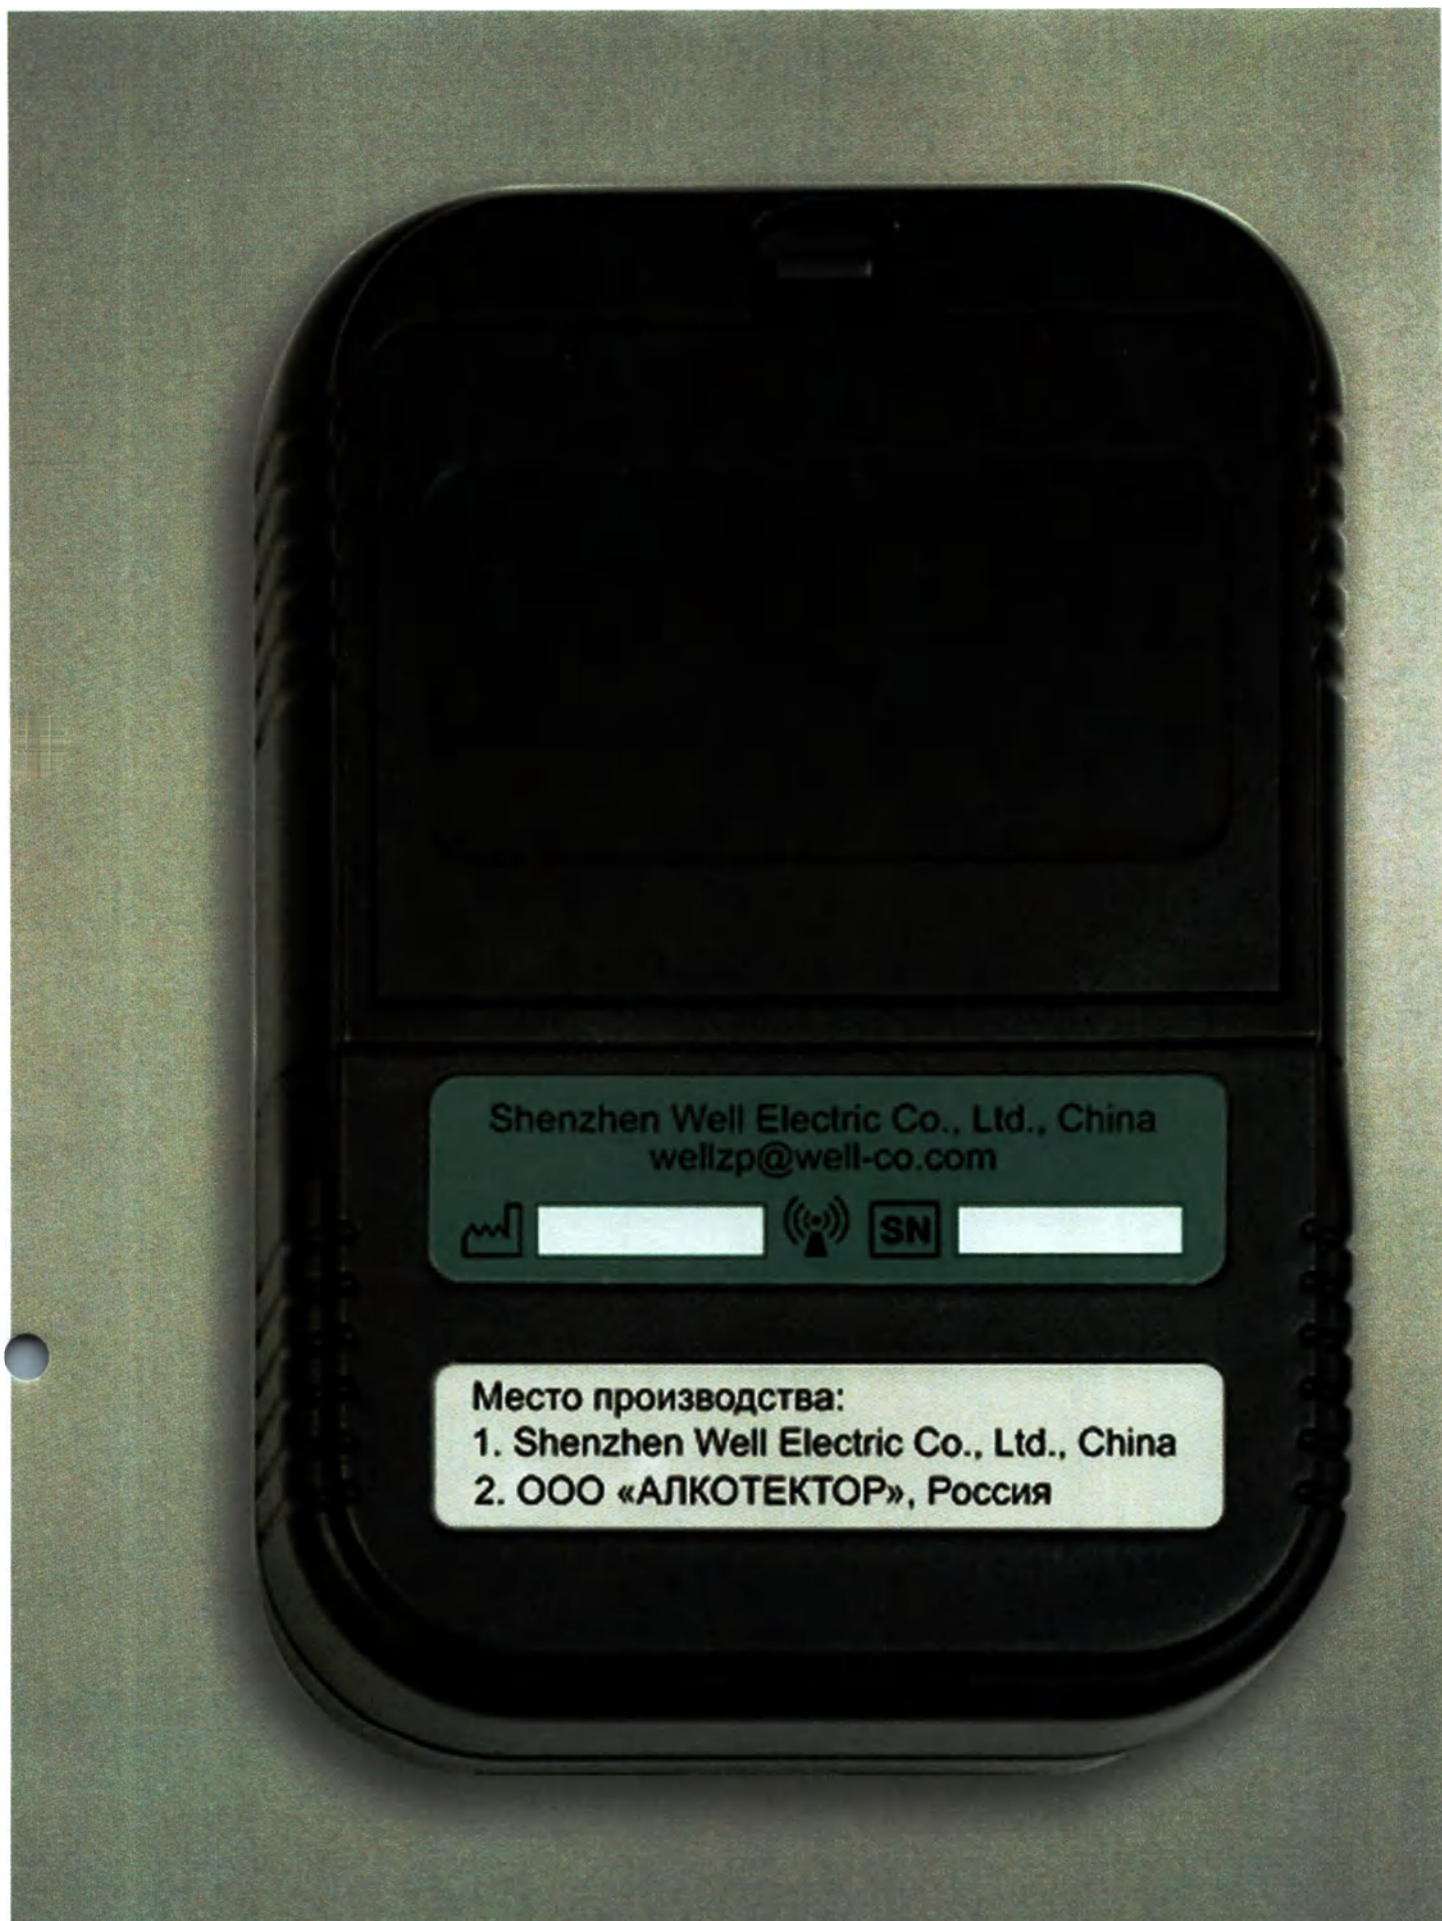

Термопринтер (вид сзади)

Аккумуляторный блок

Модель: 723759



Не ударять

**Внимание!
При нагреве
взрывается!!!**

Ёмкость: 2000 мА·ч

Не разбирать

**Номинальное напряжение:
7,4 В**

**Использовать специализированное
зарядное устройство**

Напряжение заряда: 8,4 В

**Не нагревать и не держать
рядом с огнем**

**Дата производства:
02. 2023**


**Заряжать при температуре
от 0 до 45 °С**



Партия: 2023020100510



Термобумага

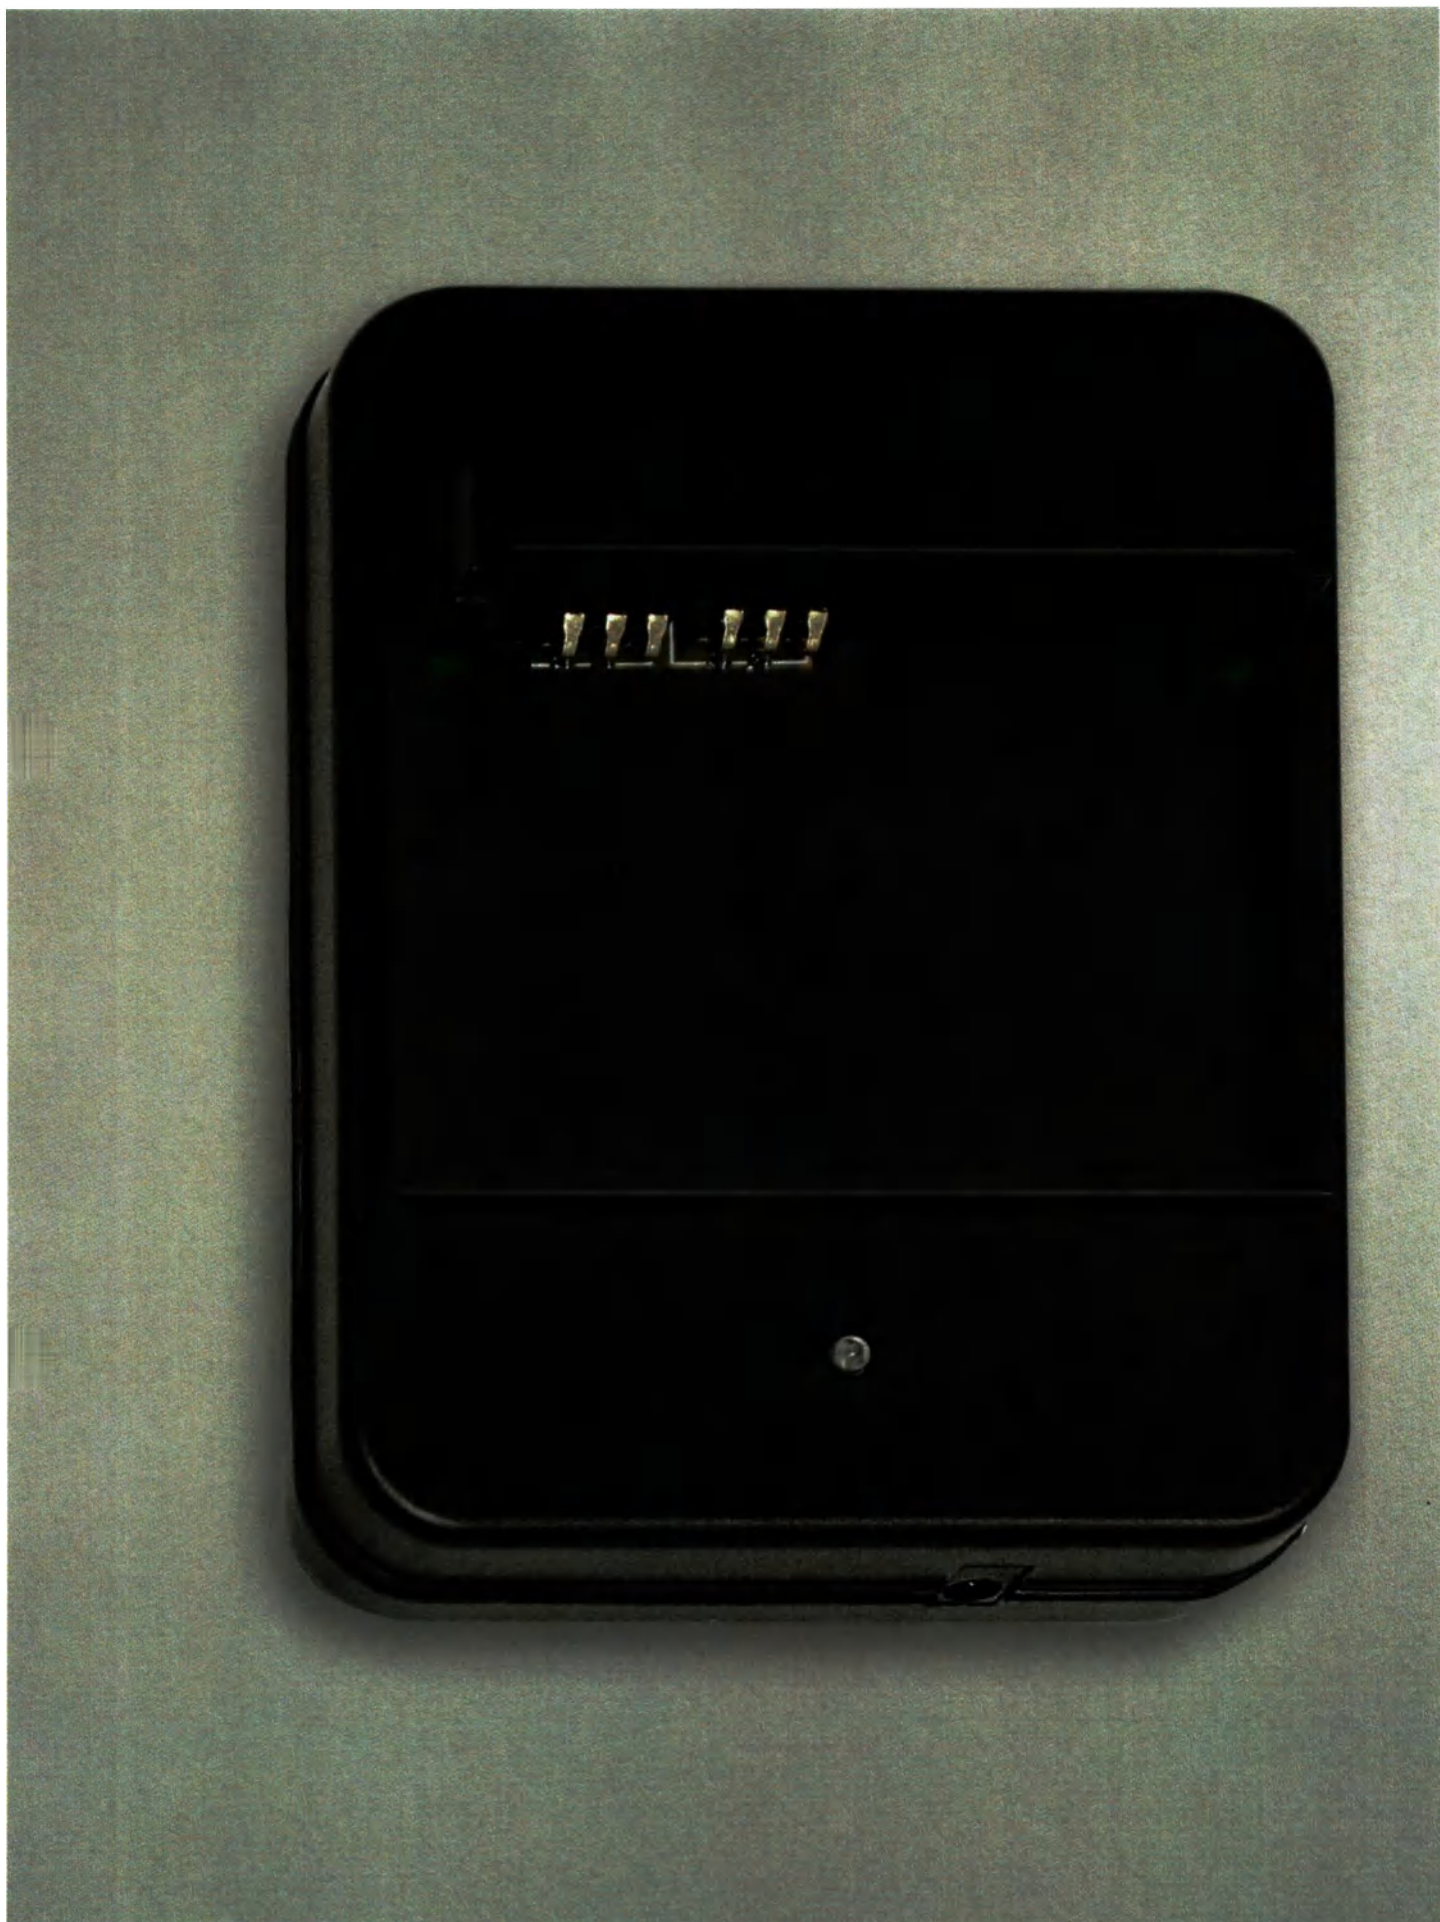


Зарядное устройство (вид спереди)



Зарядное устройство (вид сзади)



Сетевой адаптер питания зарядного устройства (вид спереди)

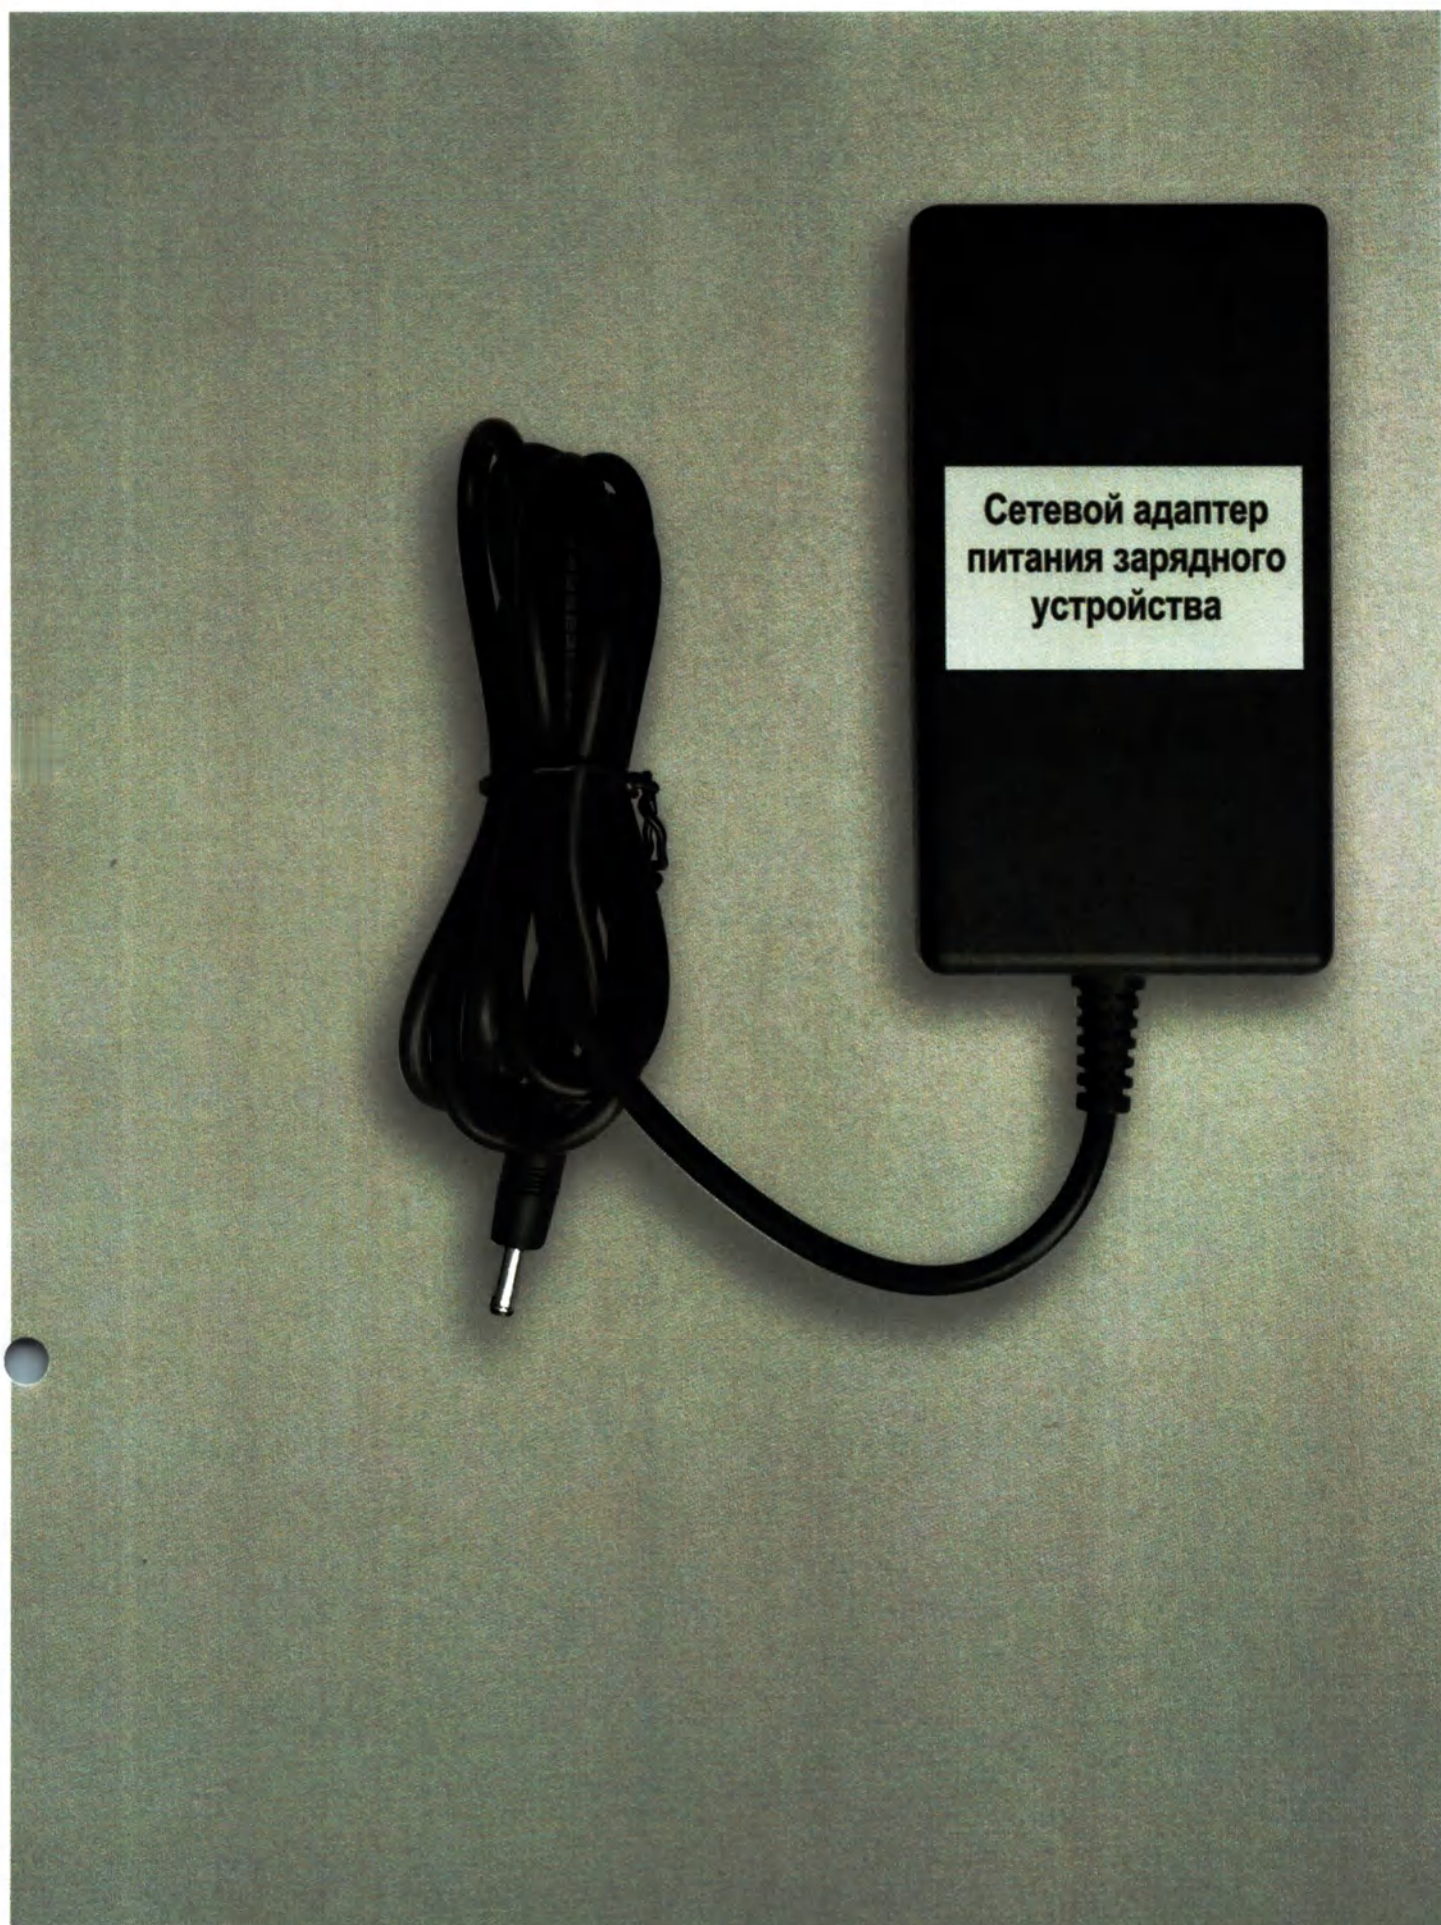

Сетевой адаптер питания зарядного устройства (вид сзади)



Бортовой адаптер питания зарядного устройства

**Бортовой адаптер питания
зарядного устройства**

для анализаторов паров этанола
в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



 03.2023

LOT 202303

Бортовой адаптер питания зарядного устройства в упаковке

Бортовой адаптер питания зарядного устройства

для анализаторов паров этанола
в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China


wellzp@well-co.com



LOT



Сетевой адаптер питания анализатора

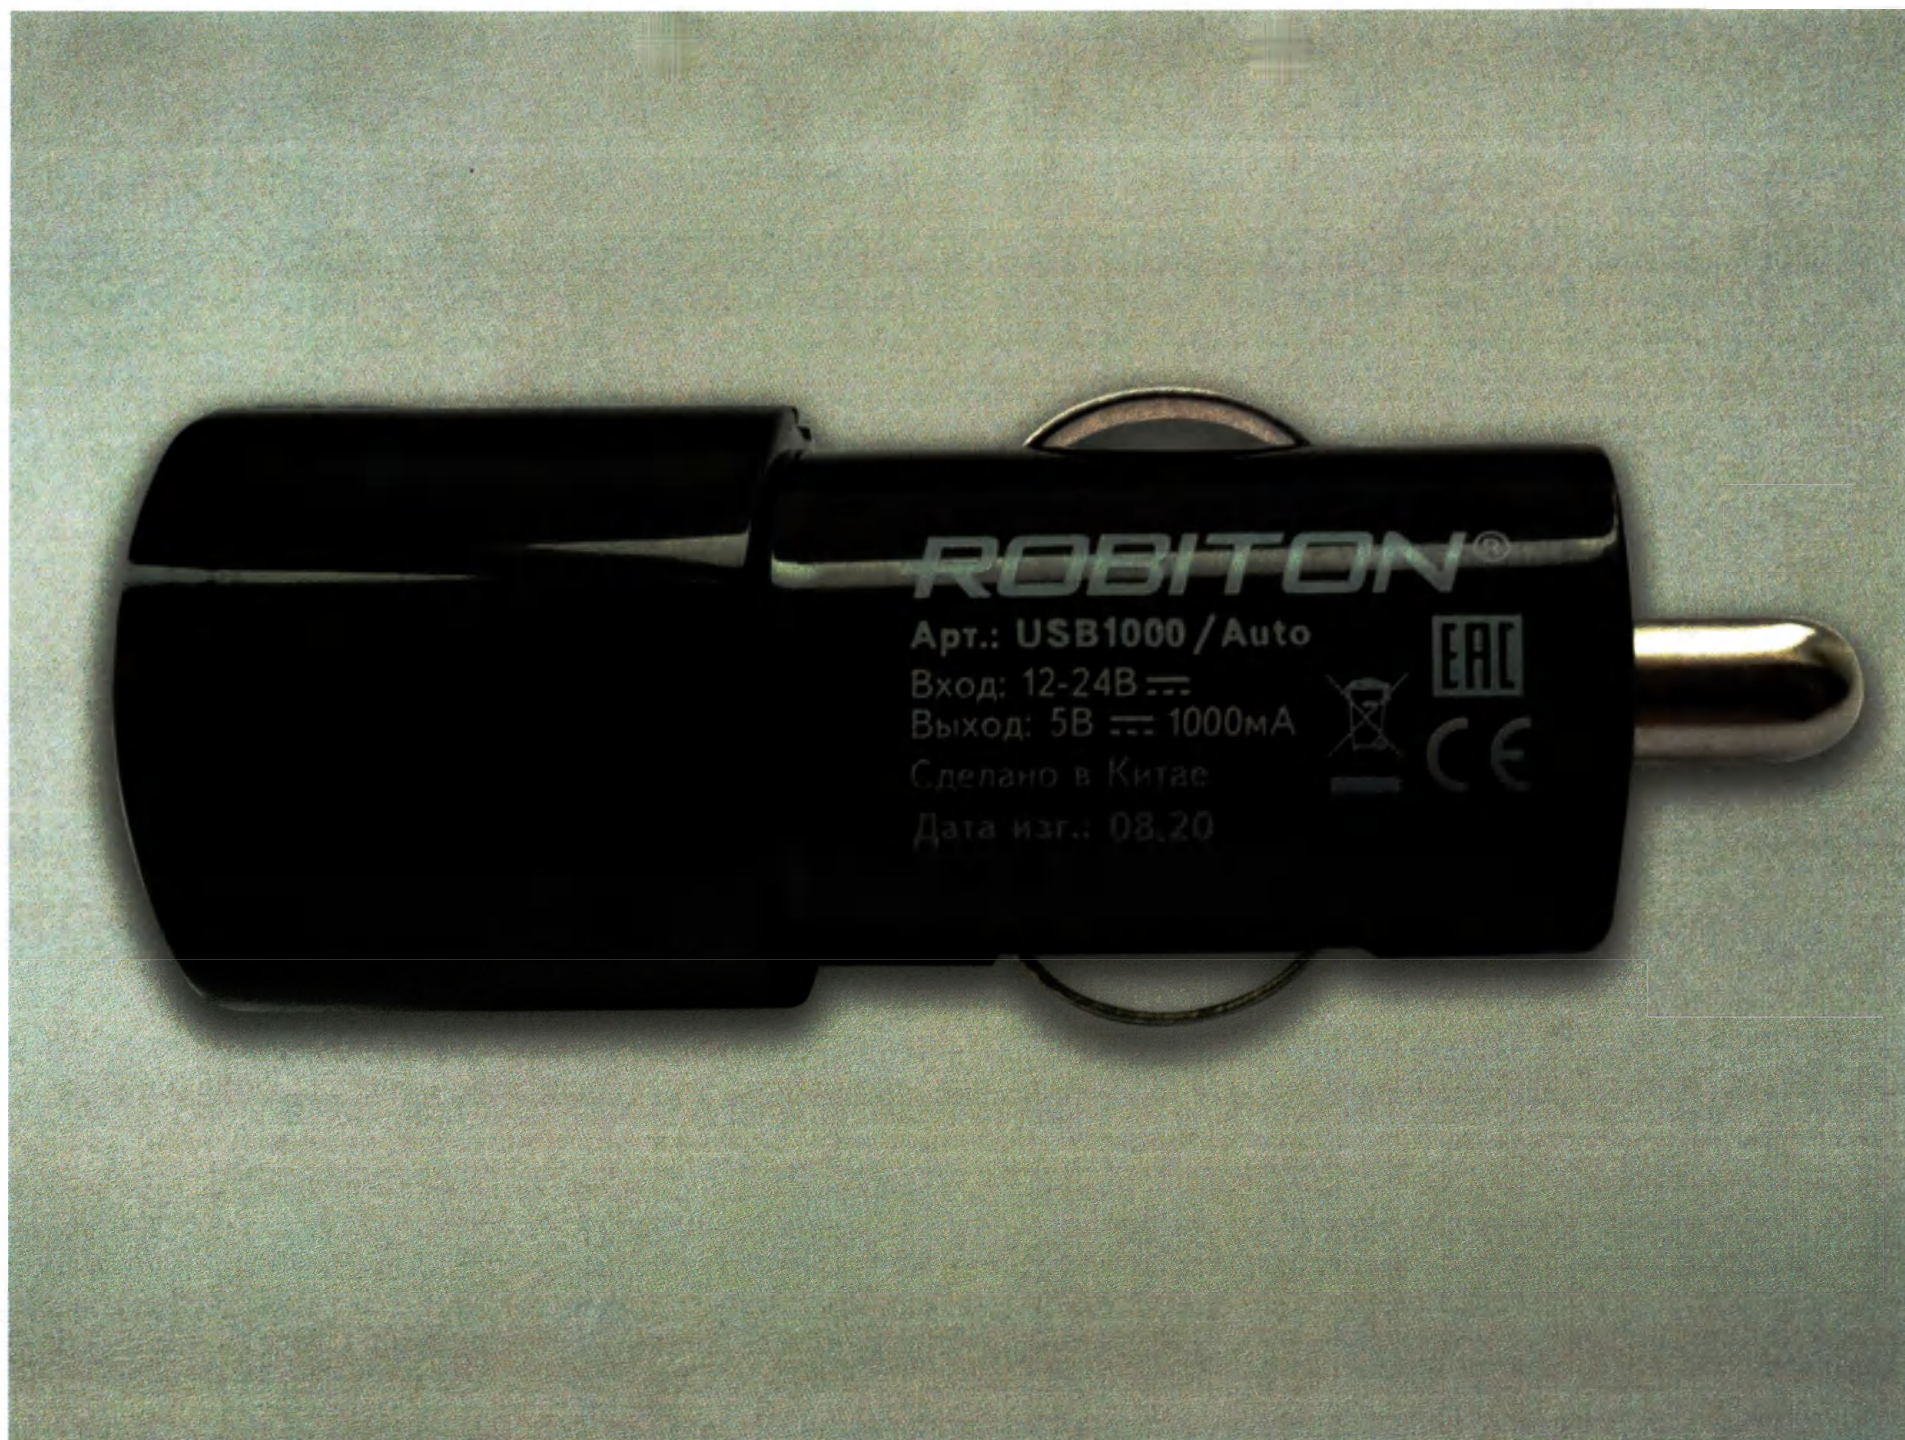



Кабель питания анализатора



Интерфейсный кабель

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено
подписью и печатью

38 (тридцать восемь) листов

Генеральный директор
ООО «АЛКОТЕКТОР»

Сидоров А.С.



Генеральный директор ООО «АЛКОТЕКТОР»



_____ А.С. Сидоров

« 30 » 05 2024 года

по доверенности Shenzhen Well Electric Co., Ltd

от 25.07.2022

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

«АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями,


вариант исполнения Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
общего вида состава медицинского изделия,
упаковки и маркировки

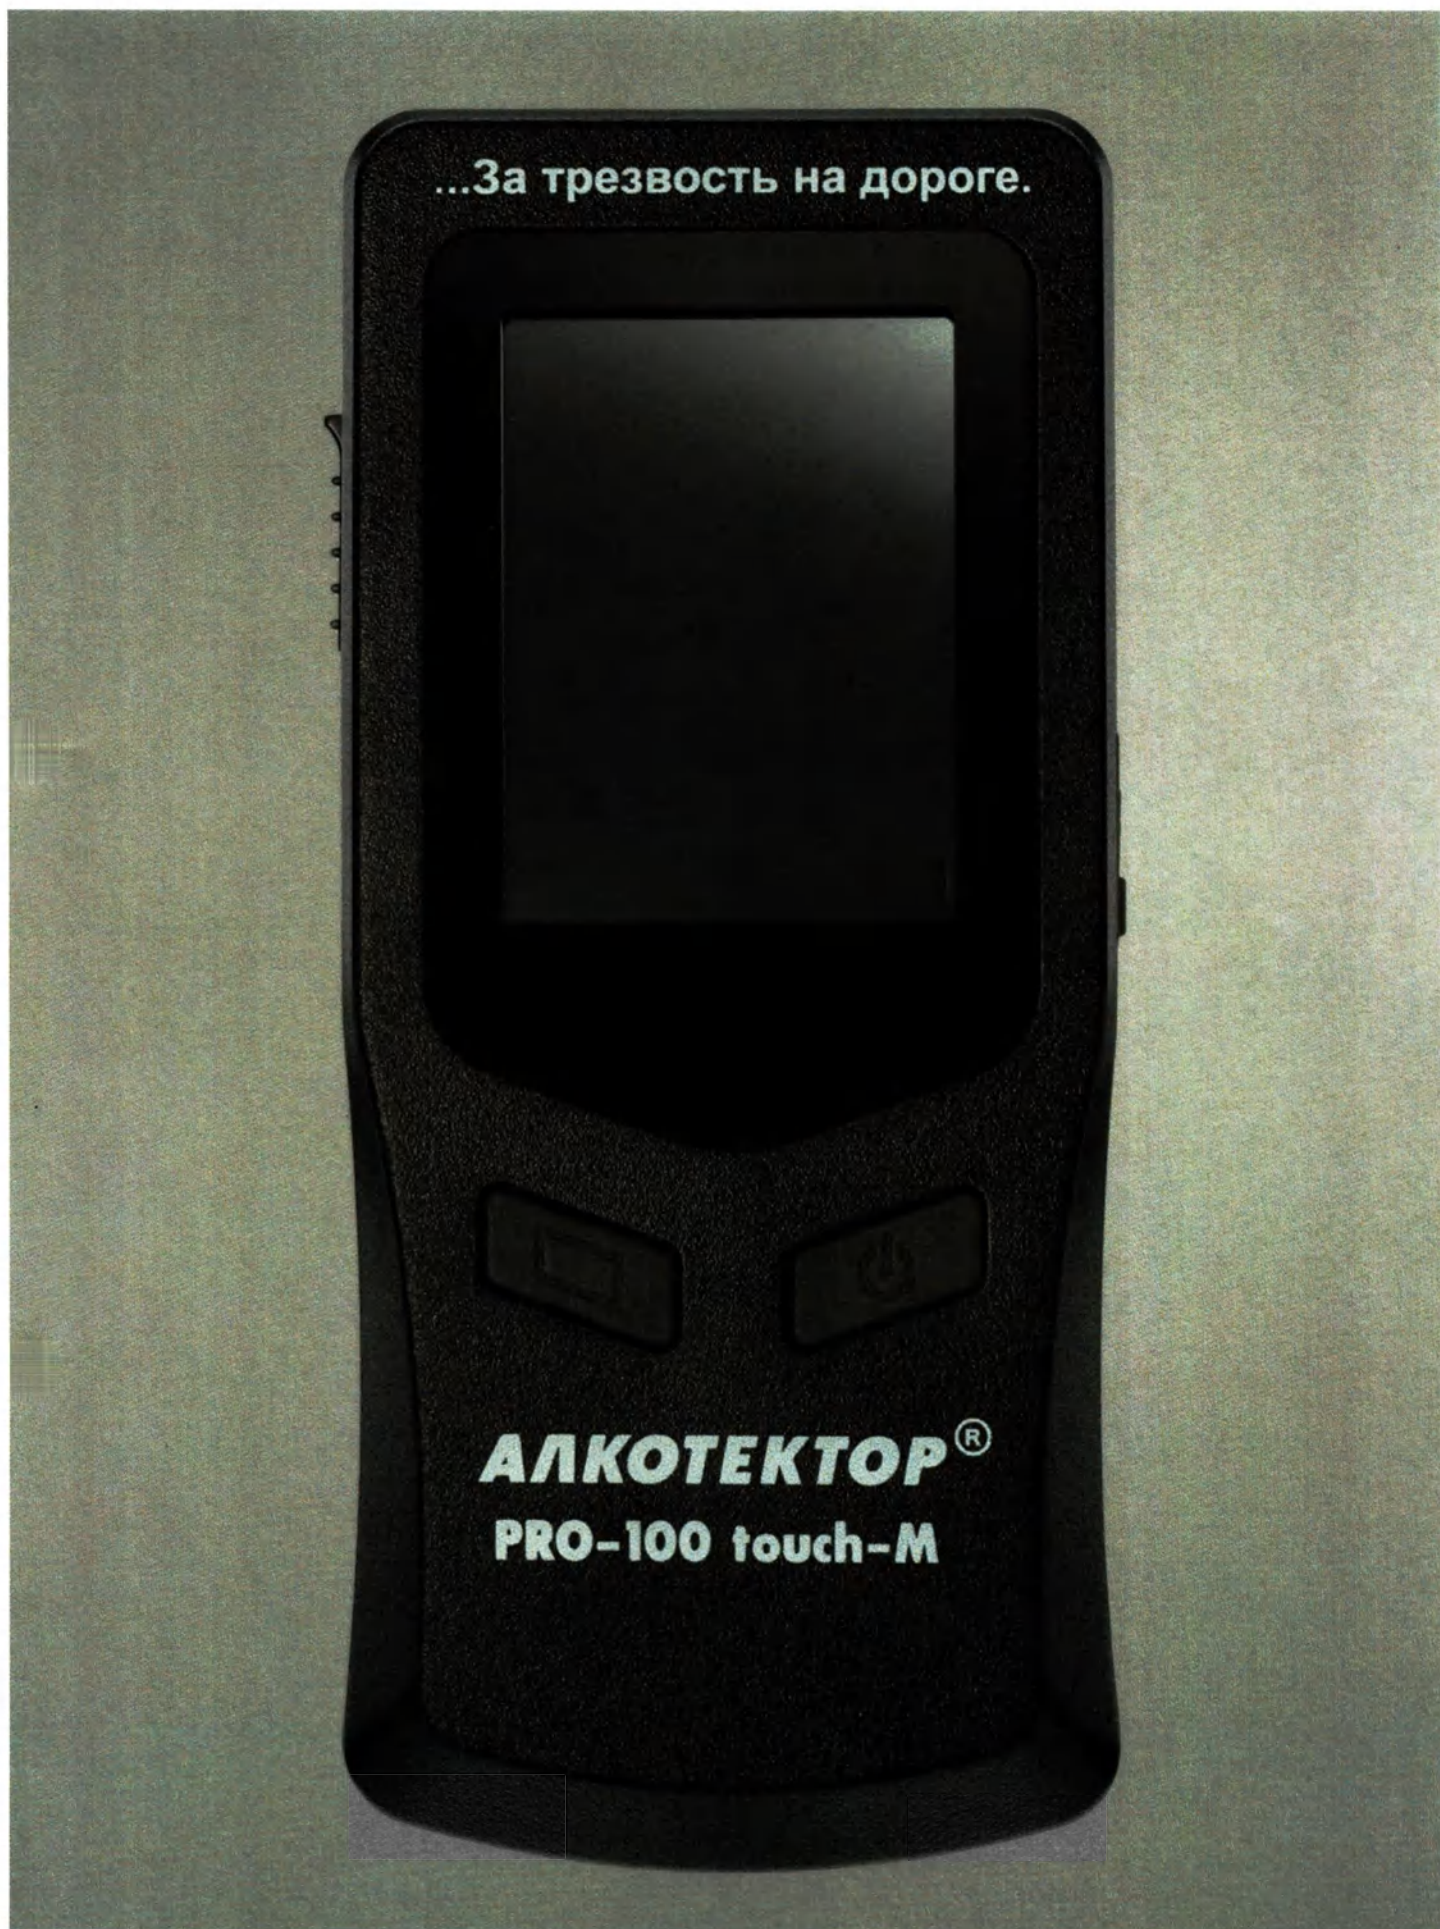

Анализатор (вид спереди)

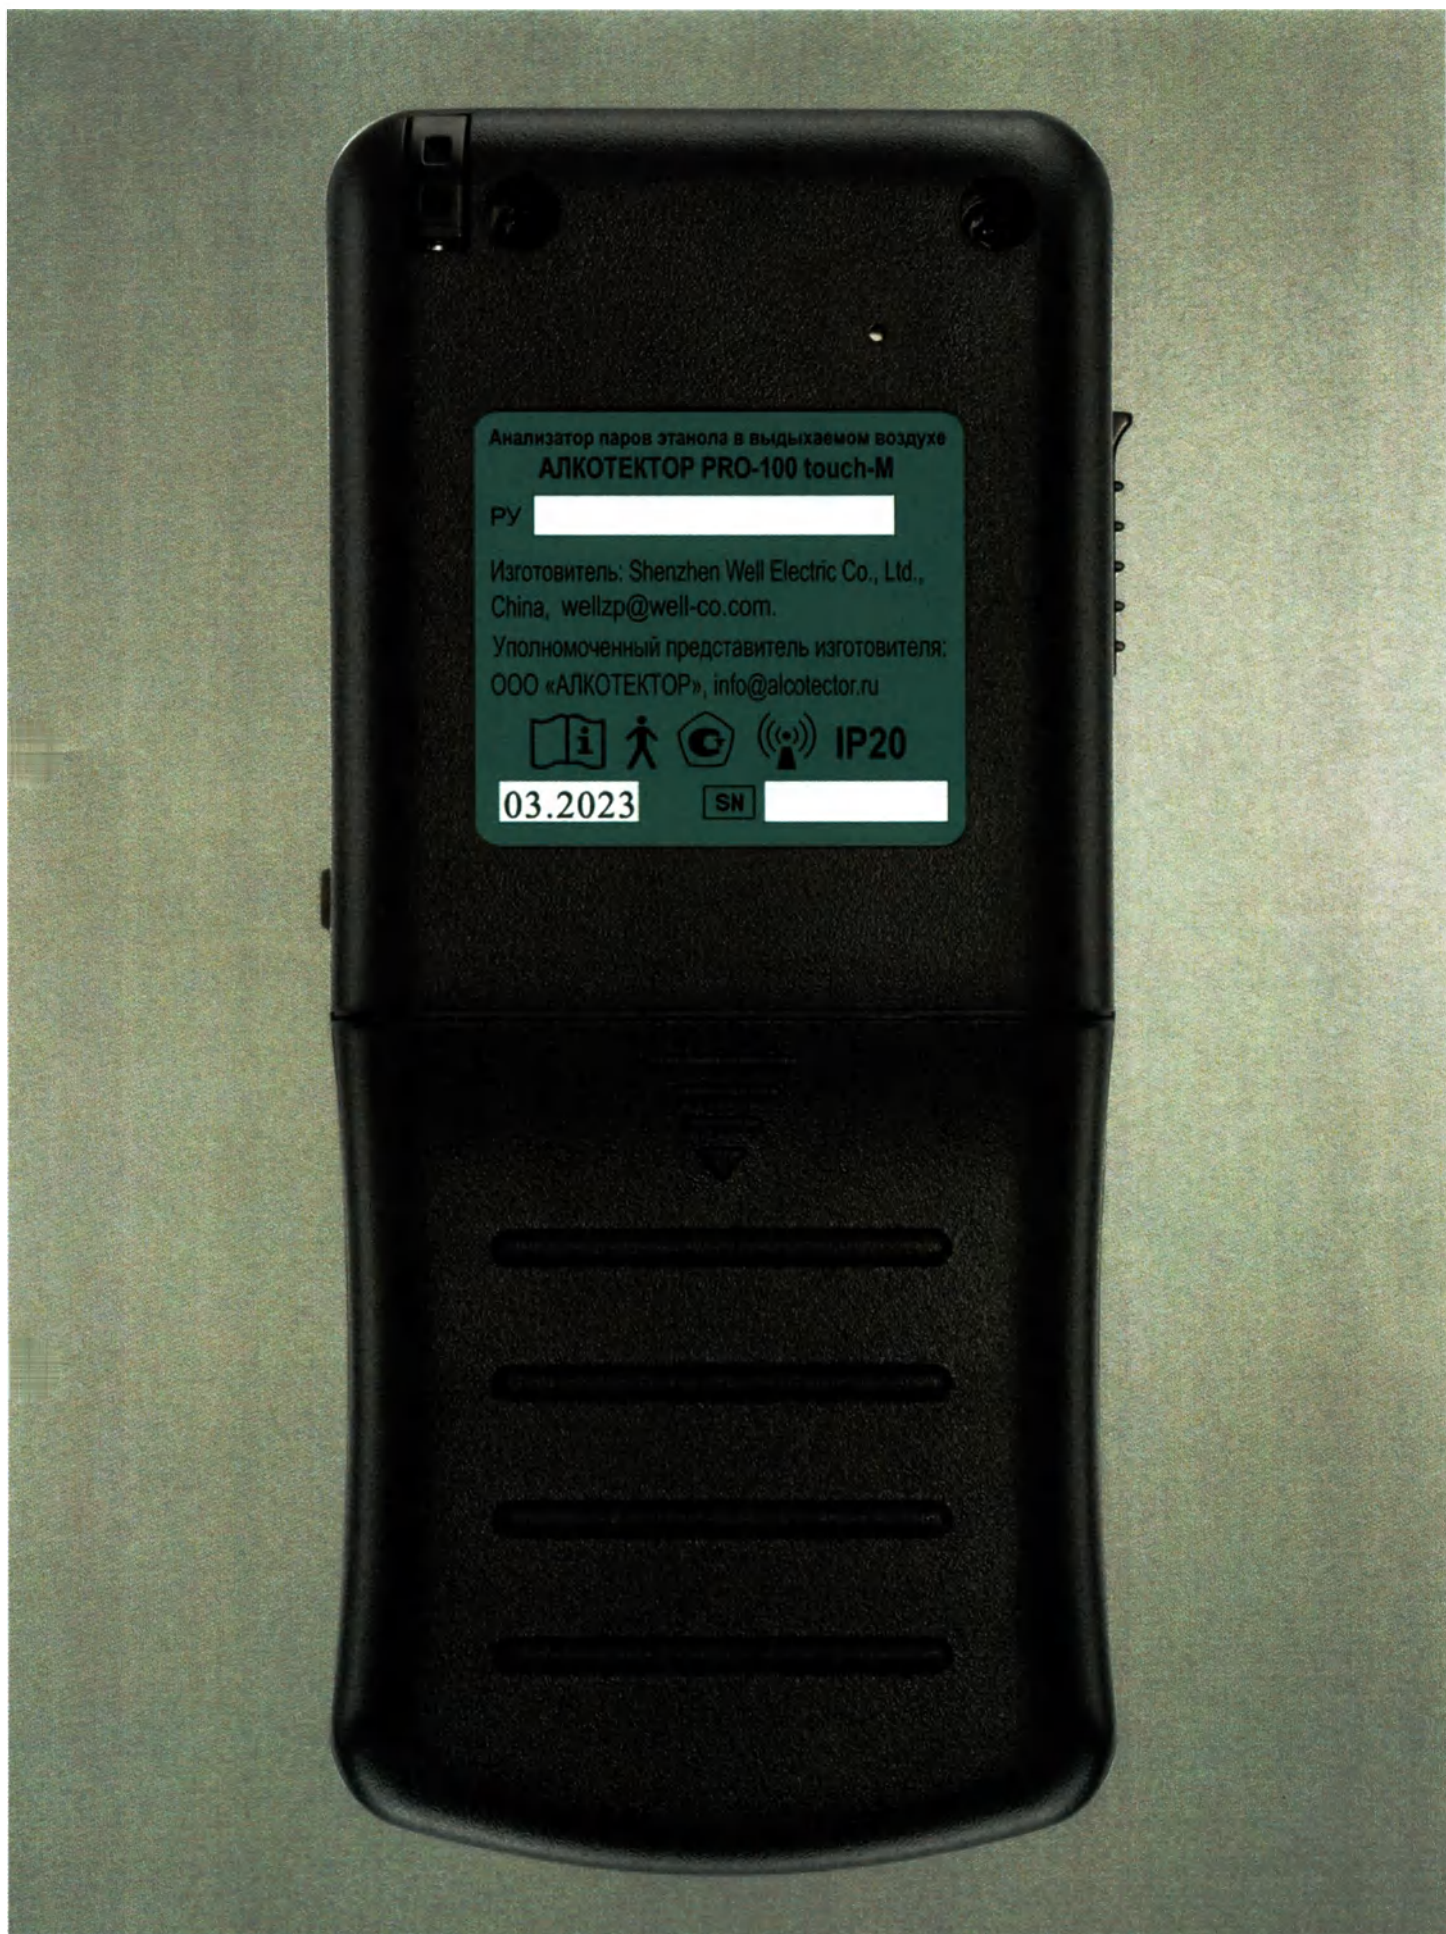

Анализатор (вид сзади)

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M

РУ

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd.,
China, wellzp@well-co.com.

Уполномоченный представитель изготовителя:
ООО «АЛКОТЕКТОР», info@alcotector.ru




IP20

SN



Мундштук

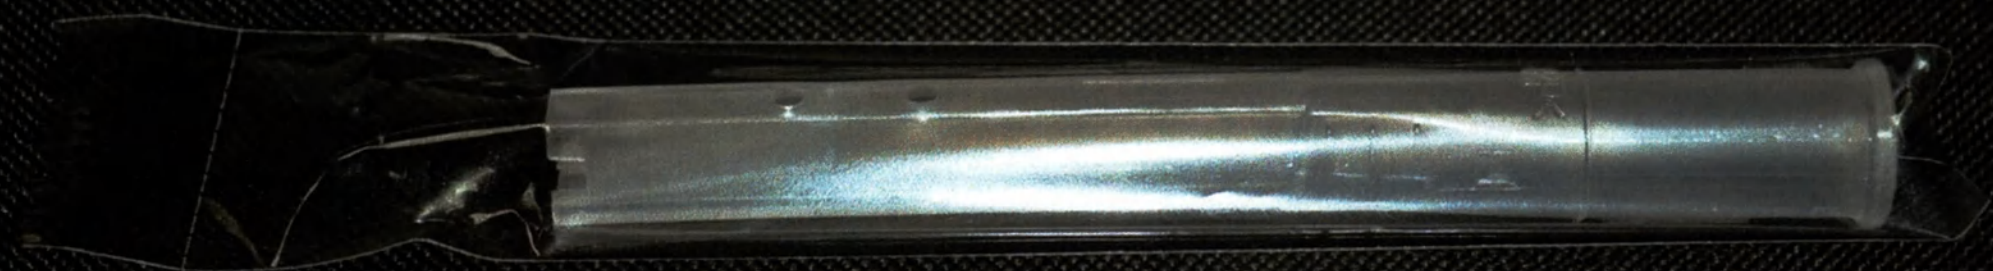

Мундштук в первичной упаковке

Мундштук



Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China

1-3F, Building 101, No. 407, HeDongCun, HengKeng, GuanCheng
Community, GuanHu Street, Longhua District, Shenzhen City,
Guangdong, China

МУНДШТУК **ШТ.**

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus



Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



Hexon



Изготовитель:
Shenzhen Well Electric Co., Ltd., Китай

АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА
В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ


«АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M»

с принадлежностями


Уполномоченный представитель изготовителя в России:
ООО «АЛКОТЕКТОР», www.alcotector.ru



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
общего вида принадлежностей медицинского изделия,
упаковки и маркировки

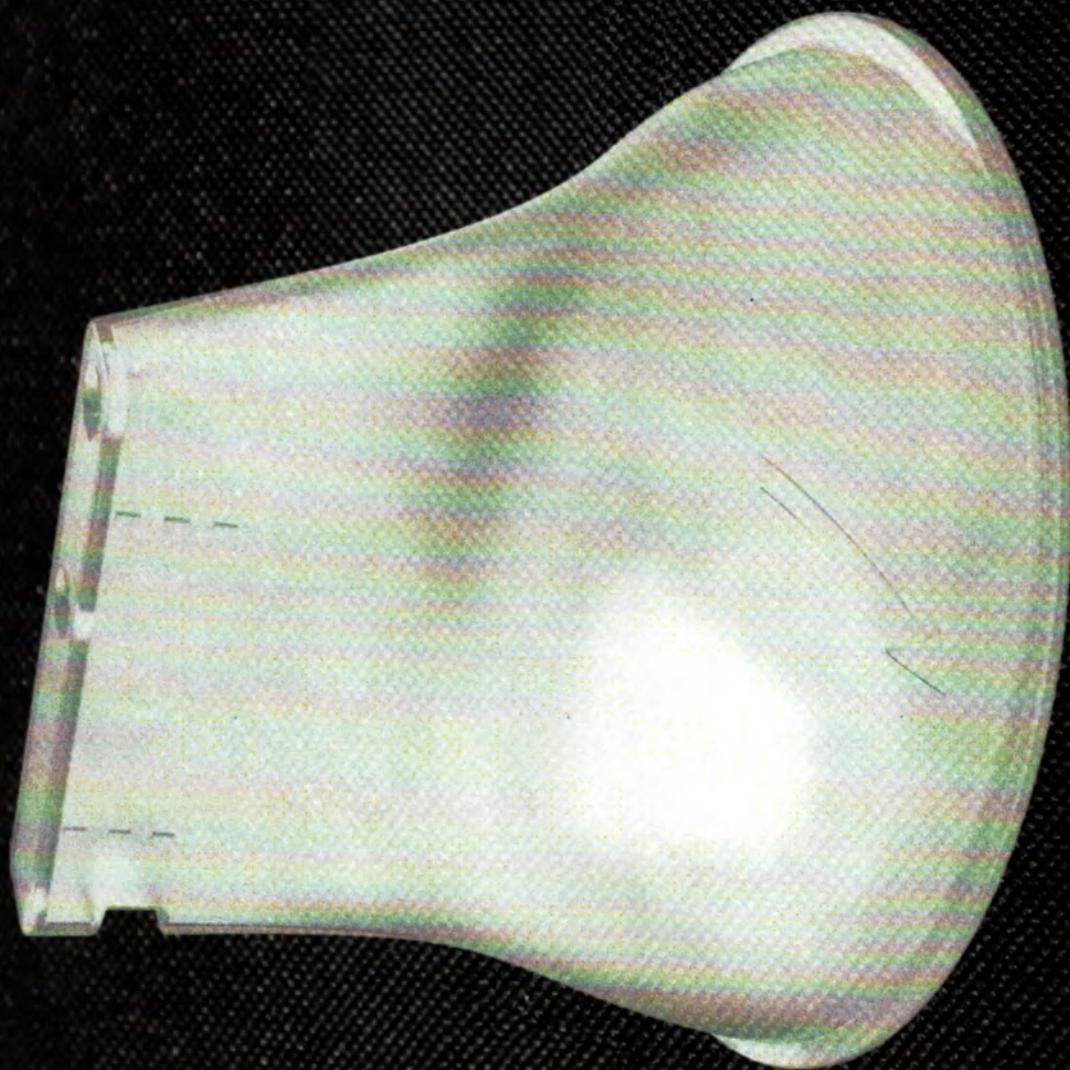

Мундштук -воронка

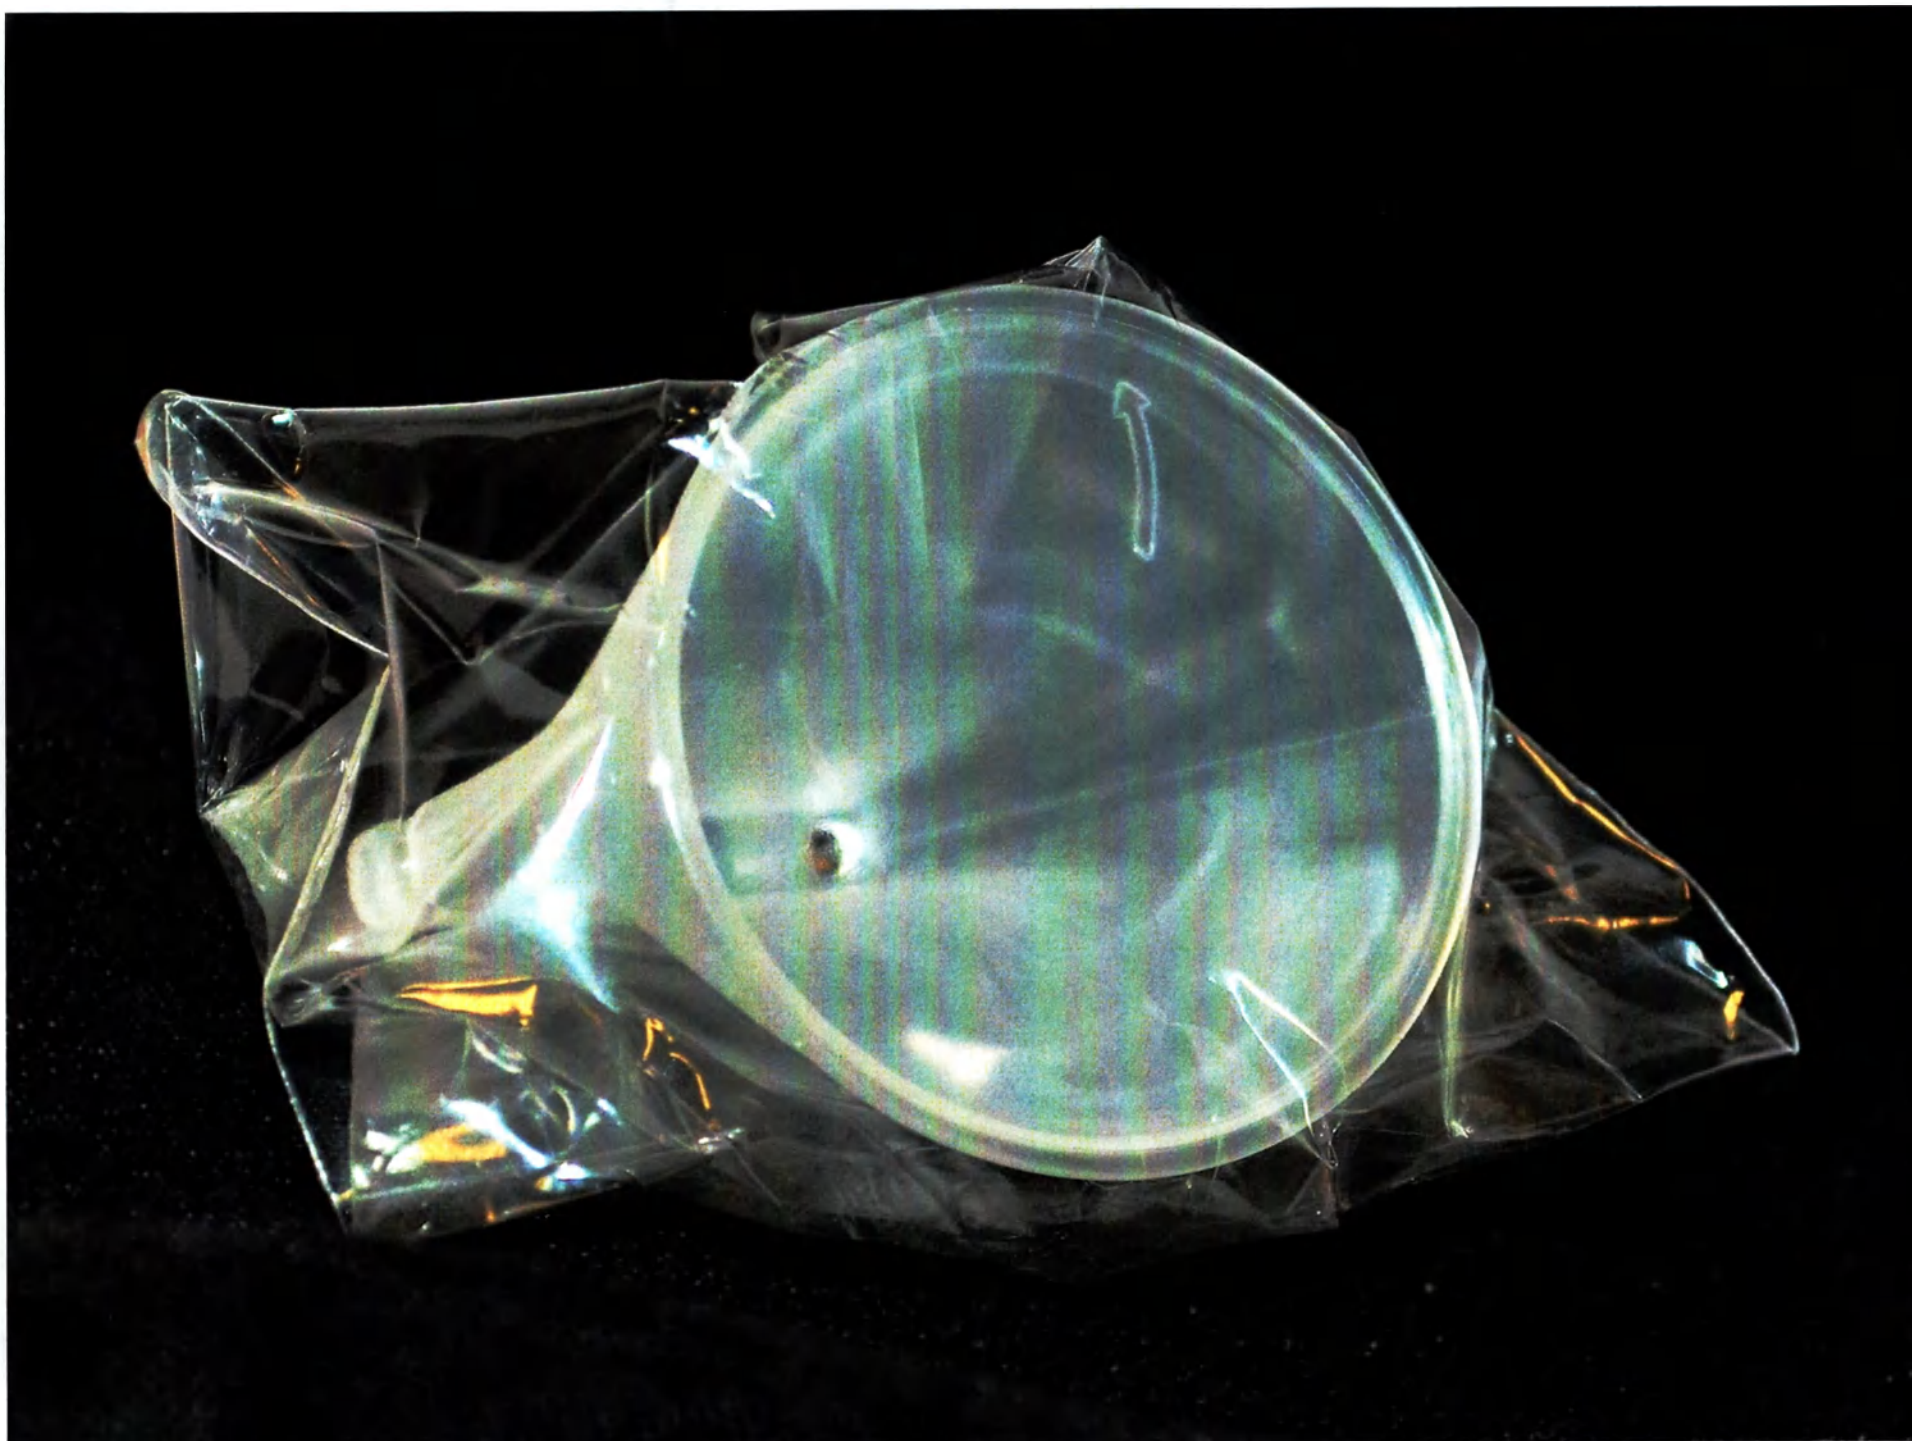

Мундштук-воронка в упаковке

МУНДШТУК-ВОРОНКА

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K,



для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
«АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К»,
«Юпитер-П»,




LOT

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015).
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»

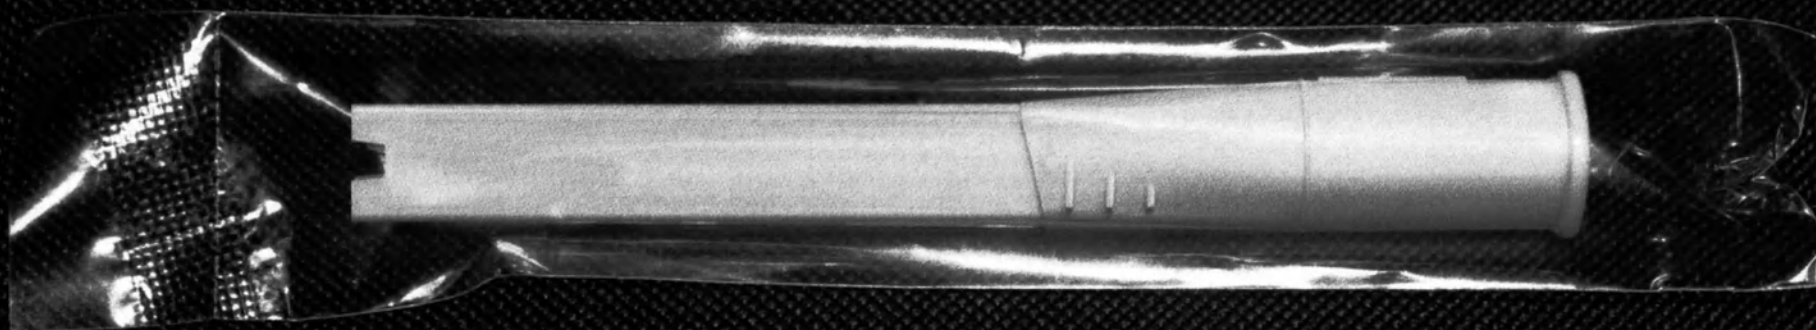

Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»
в первичной упаковке

Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015)



ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н.



Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»



ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н.

Сделано в России



LOT

ШТ.




Кабель USB



Кабель USB

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K,

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus



Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com

 03.2023

LOT 202303

Кабель USB в упаковке

Кабель USB

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K,

для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus



Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China

wellzp@well-co.com




LOT

WPT-2
Thermal Printer


... За трезвость на дороге.

АЛКОТЕКТОР®

Термопринтер (вид спереди)

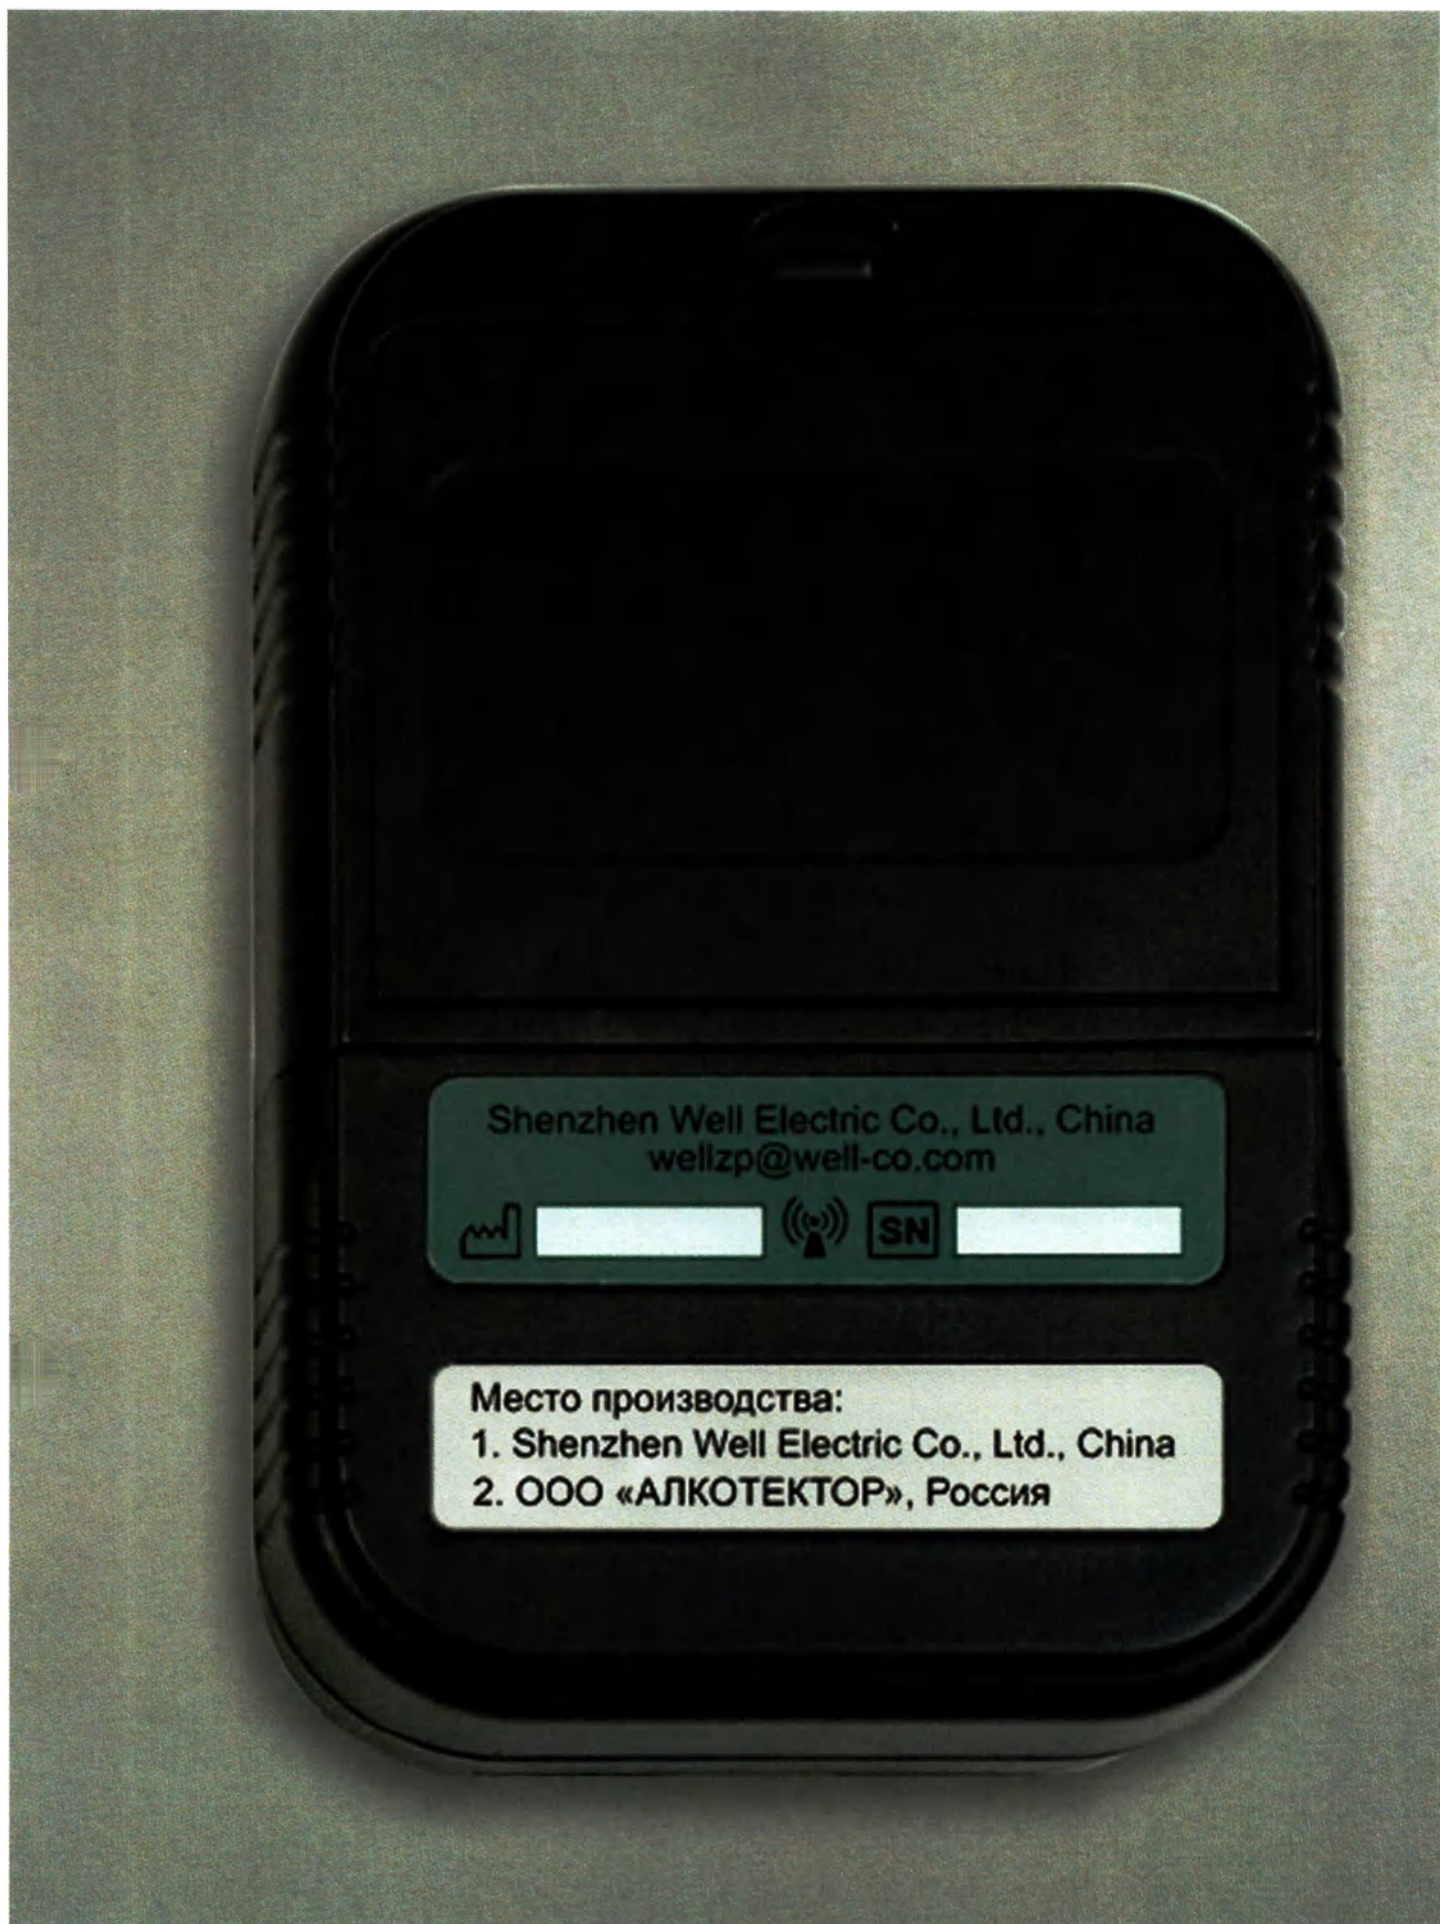

Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



Место производства:

1. Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
2. ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия

Термопринтер (вид сзади)

Аккумуляторный блок

Модель: 723759



Не ударять

Ёмкость: 2000 мА·ч

Не разбирать

**Внимание!
При нагреве
взрывается!!!**

**Номинальное напряжение:
7,4 В**

**Использовать специализированное
зарядное устройство**

Напряжение заряда: 8,4 В

**Не нагревать и не держать
рядом с огнем**


**Дата производства:
02. 2023**

**Заряжать при температуре
от 0 до 45 °С**



Партия: 2023020100510



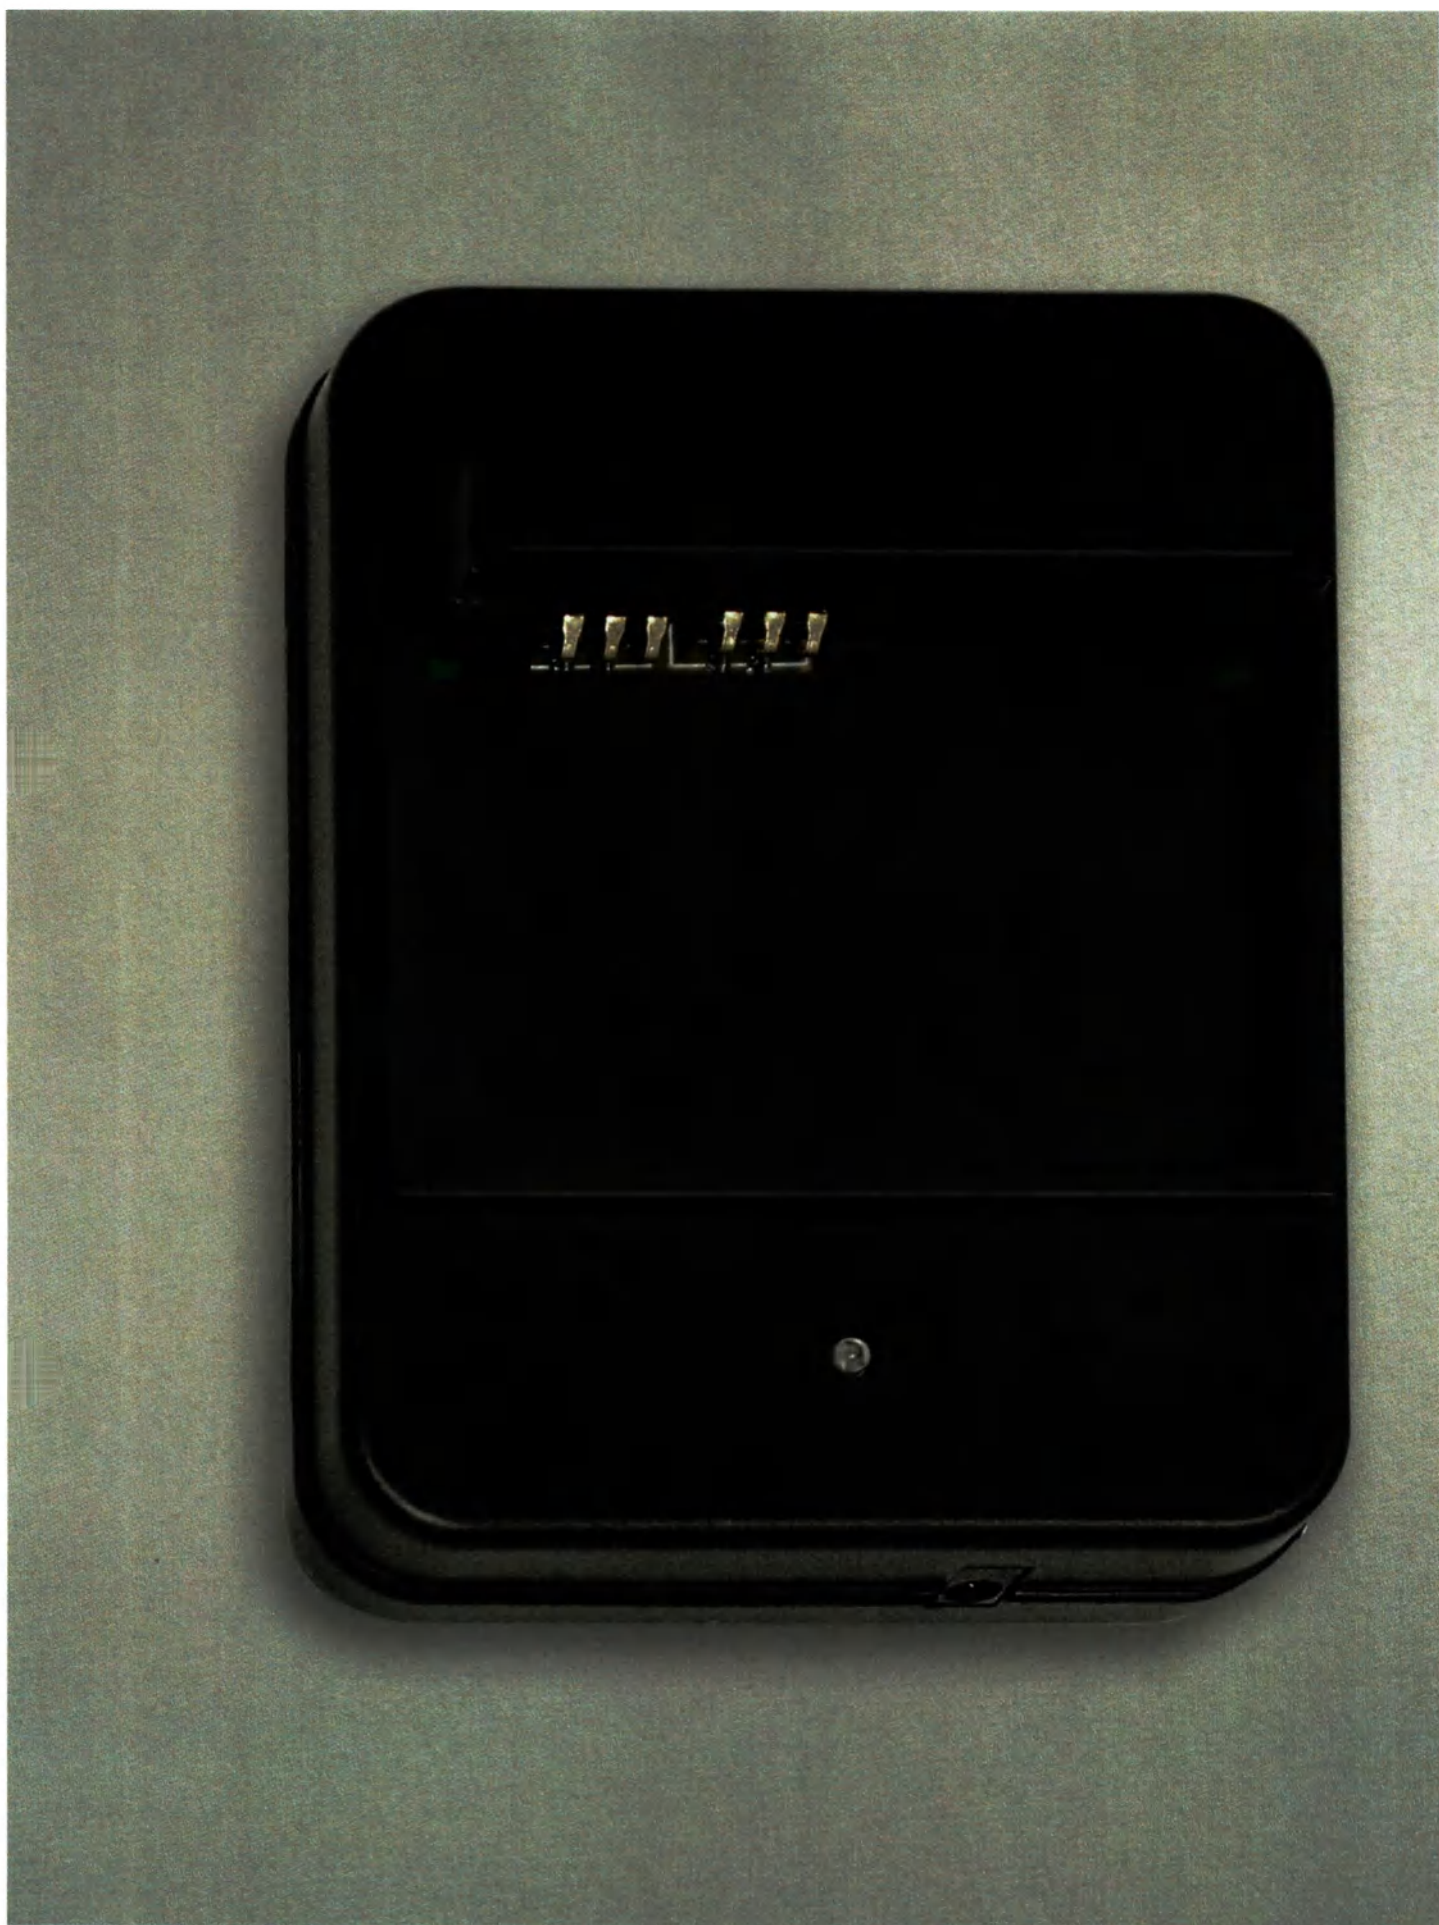

Зарядное устройство (вид спереди)



Зарядное устройство (вид сзади)



AC/DC Adapter

MODEL: BX-12003000

INPUT: AC100-240V~

50/60Hz 0.8A Max

OUTPUT: 12V --- 3A




CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DRY LOCATION USE ONLY

ATTENTION
POUR UTILISATION
L'INTÉRIEUR SEULEMENT



MADE IN CHINA

Сетевой адаптер питания зарядного устройства (вид спереди)

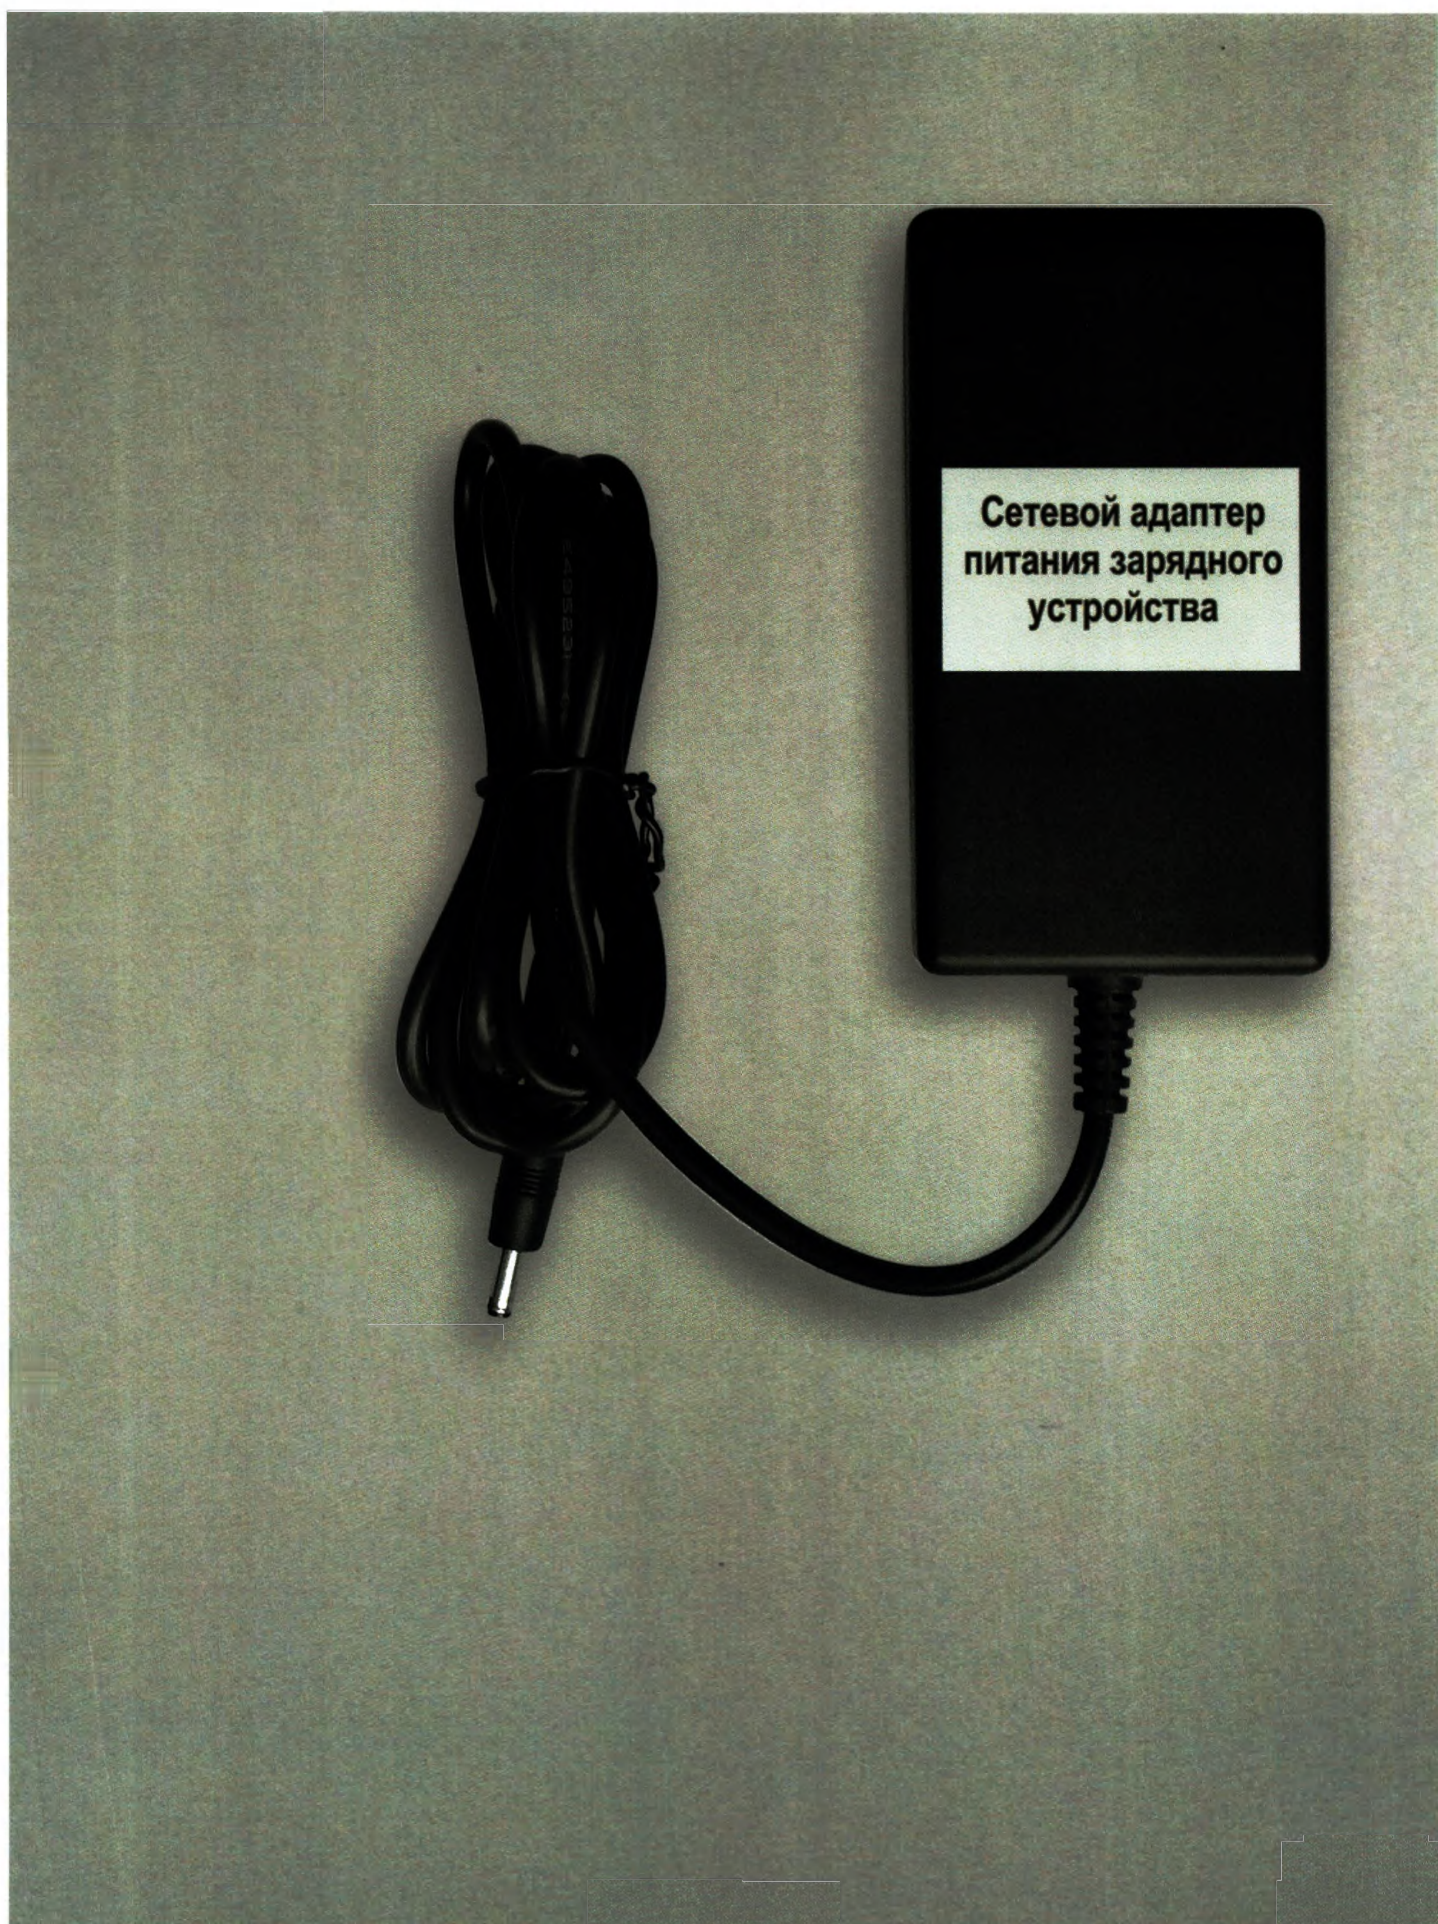

Сетевой адаптер питания зарядного устройства (вид сзади)



Бортовой адаптер питания зарядного устройства

**Бортовой адаптер питания
зарядного устройства**

для анализаторов паров этанола
в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China
wellzp@well-co.com



03.2023

LOT 202303

Бортовой адаптер питания зарядного устройства в упаковке

Бортовой адаптер питания зарядного устройства

для анализаторов паров этанола
в выдыхаемом воздухе

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M,
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus

Изготовитель: Shenzhen Well Electric Co., Ltd., China


wellzp@well-co.com



LOT



Сетевой адаптер питания анализатора

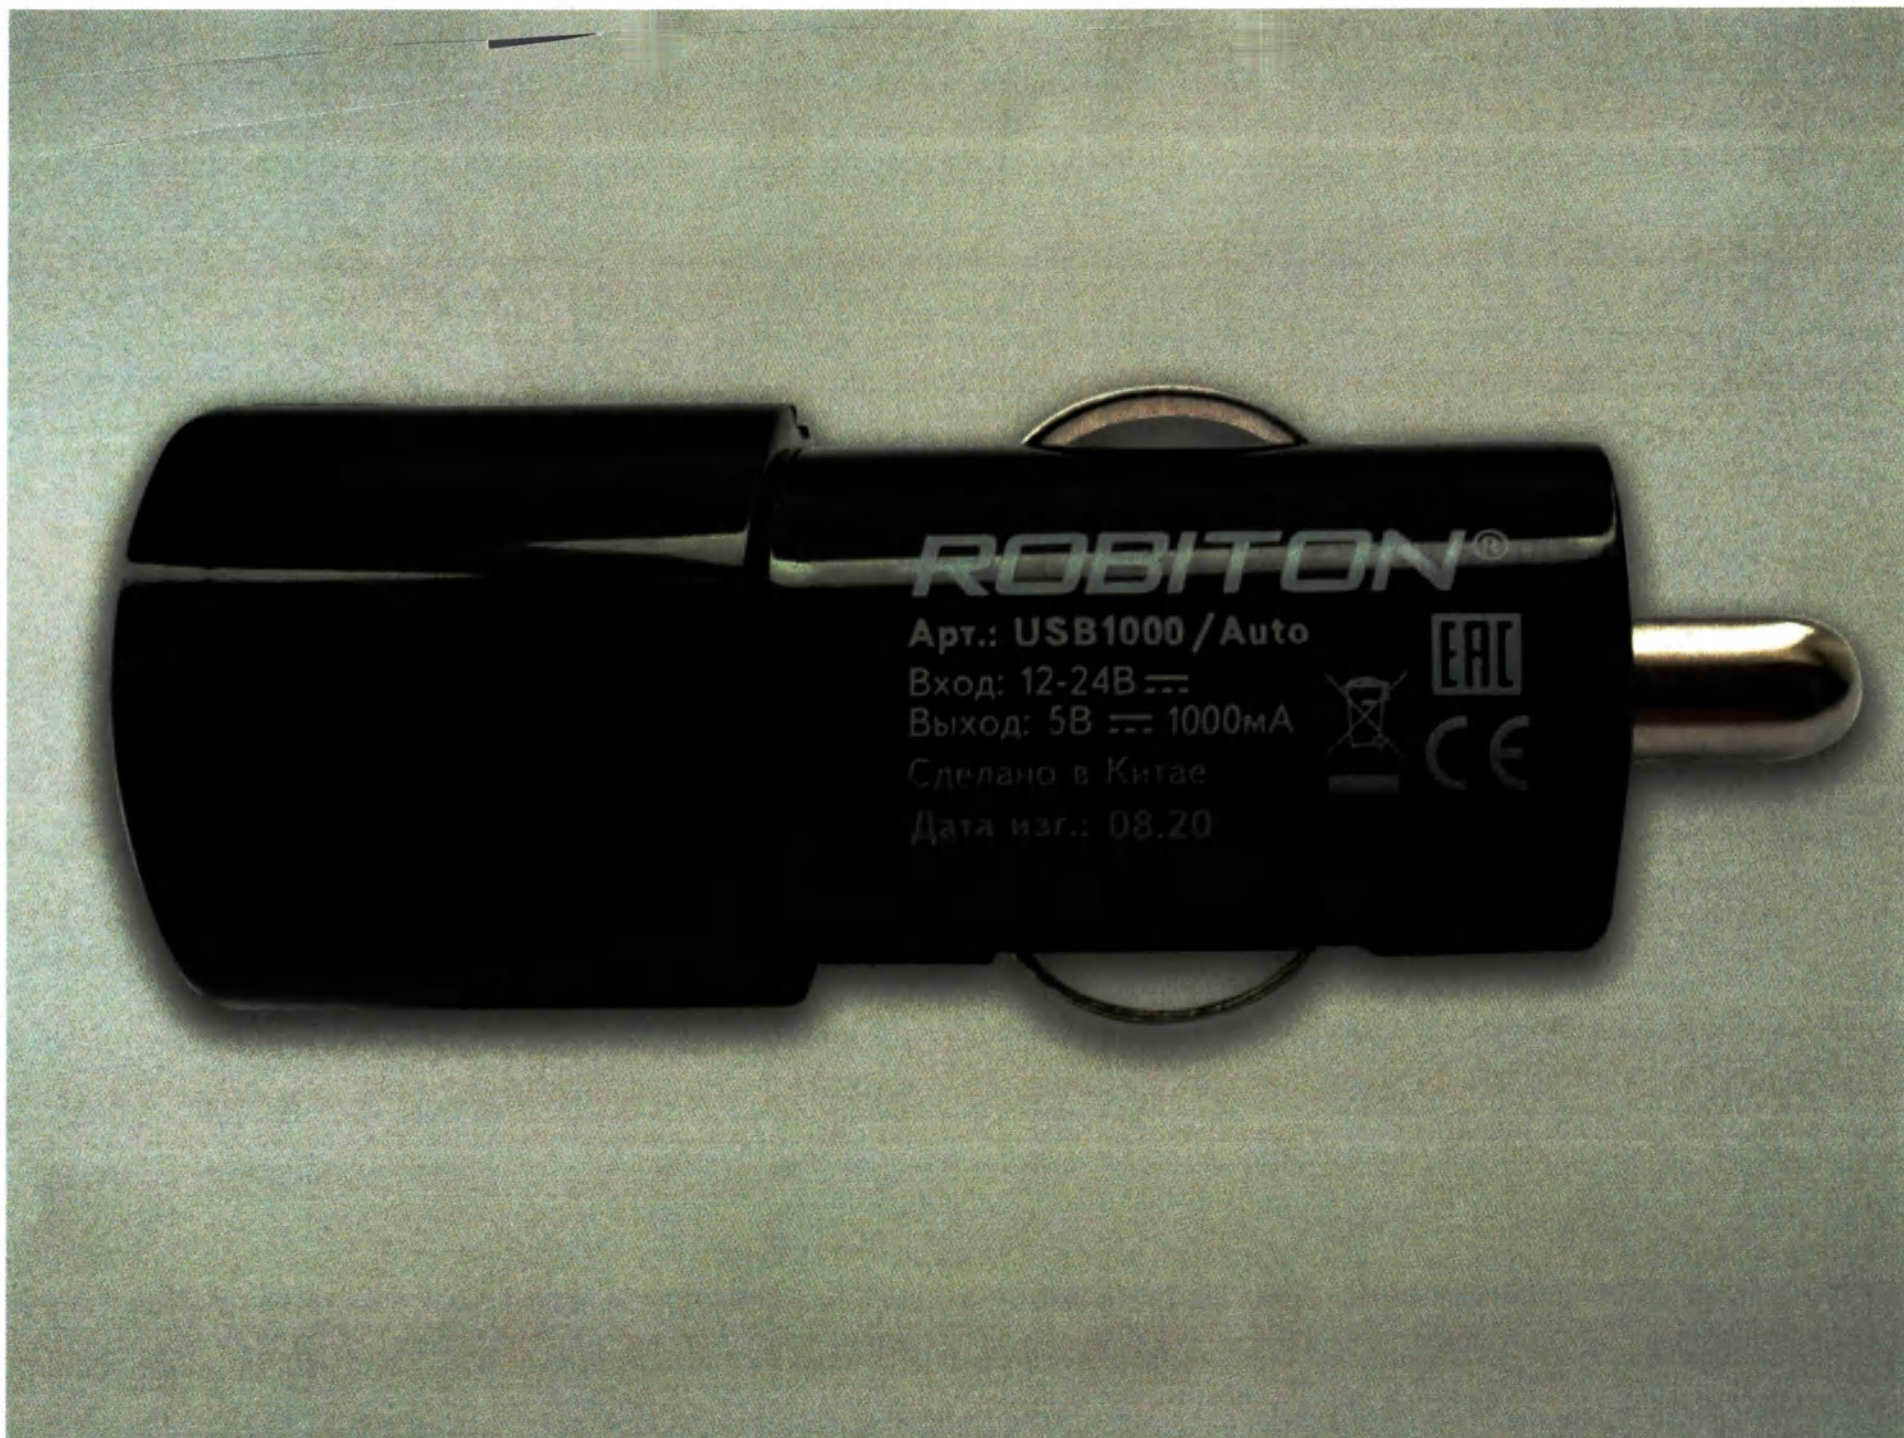

ROBITON®

Арт.: USB1000 / Auto

Вход: 12-24В ~

Выход: 5В ~ 1000мА

Сделано в Китае

Дата изг.: 08.20





Кабель питания анализатора



Интерфейсный кабель

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено
подписью и печатью

38 (тридцать восемь) лист 06

Генеральный директор

ООО «АЛКОТЕКТОР»

Сидоров А.С.

