


Общество с ограниченной ответственностью «Центр больничной гигиены»
(ООО «ЦБГ»)


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор

ООО «ЦБГ»

 Коржова Л. Ю.




 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС»
по ТУ 32.50.50-001-40718084-2023
в вариантах исполнения**


г. Москва
2023

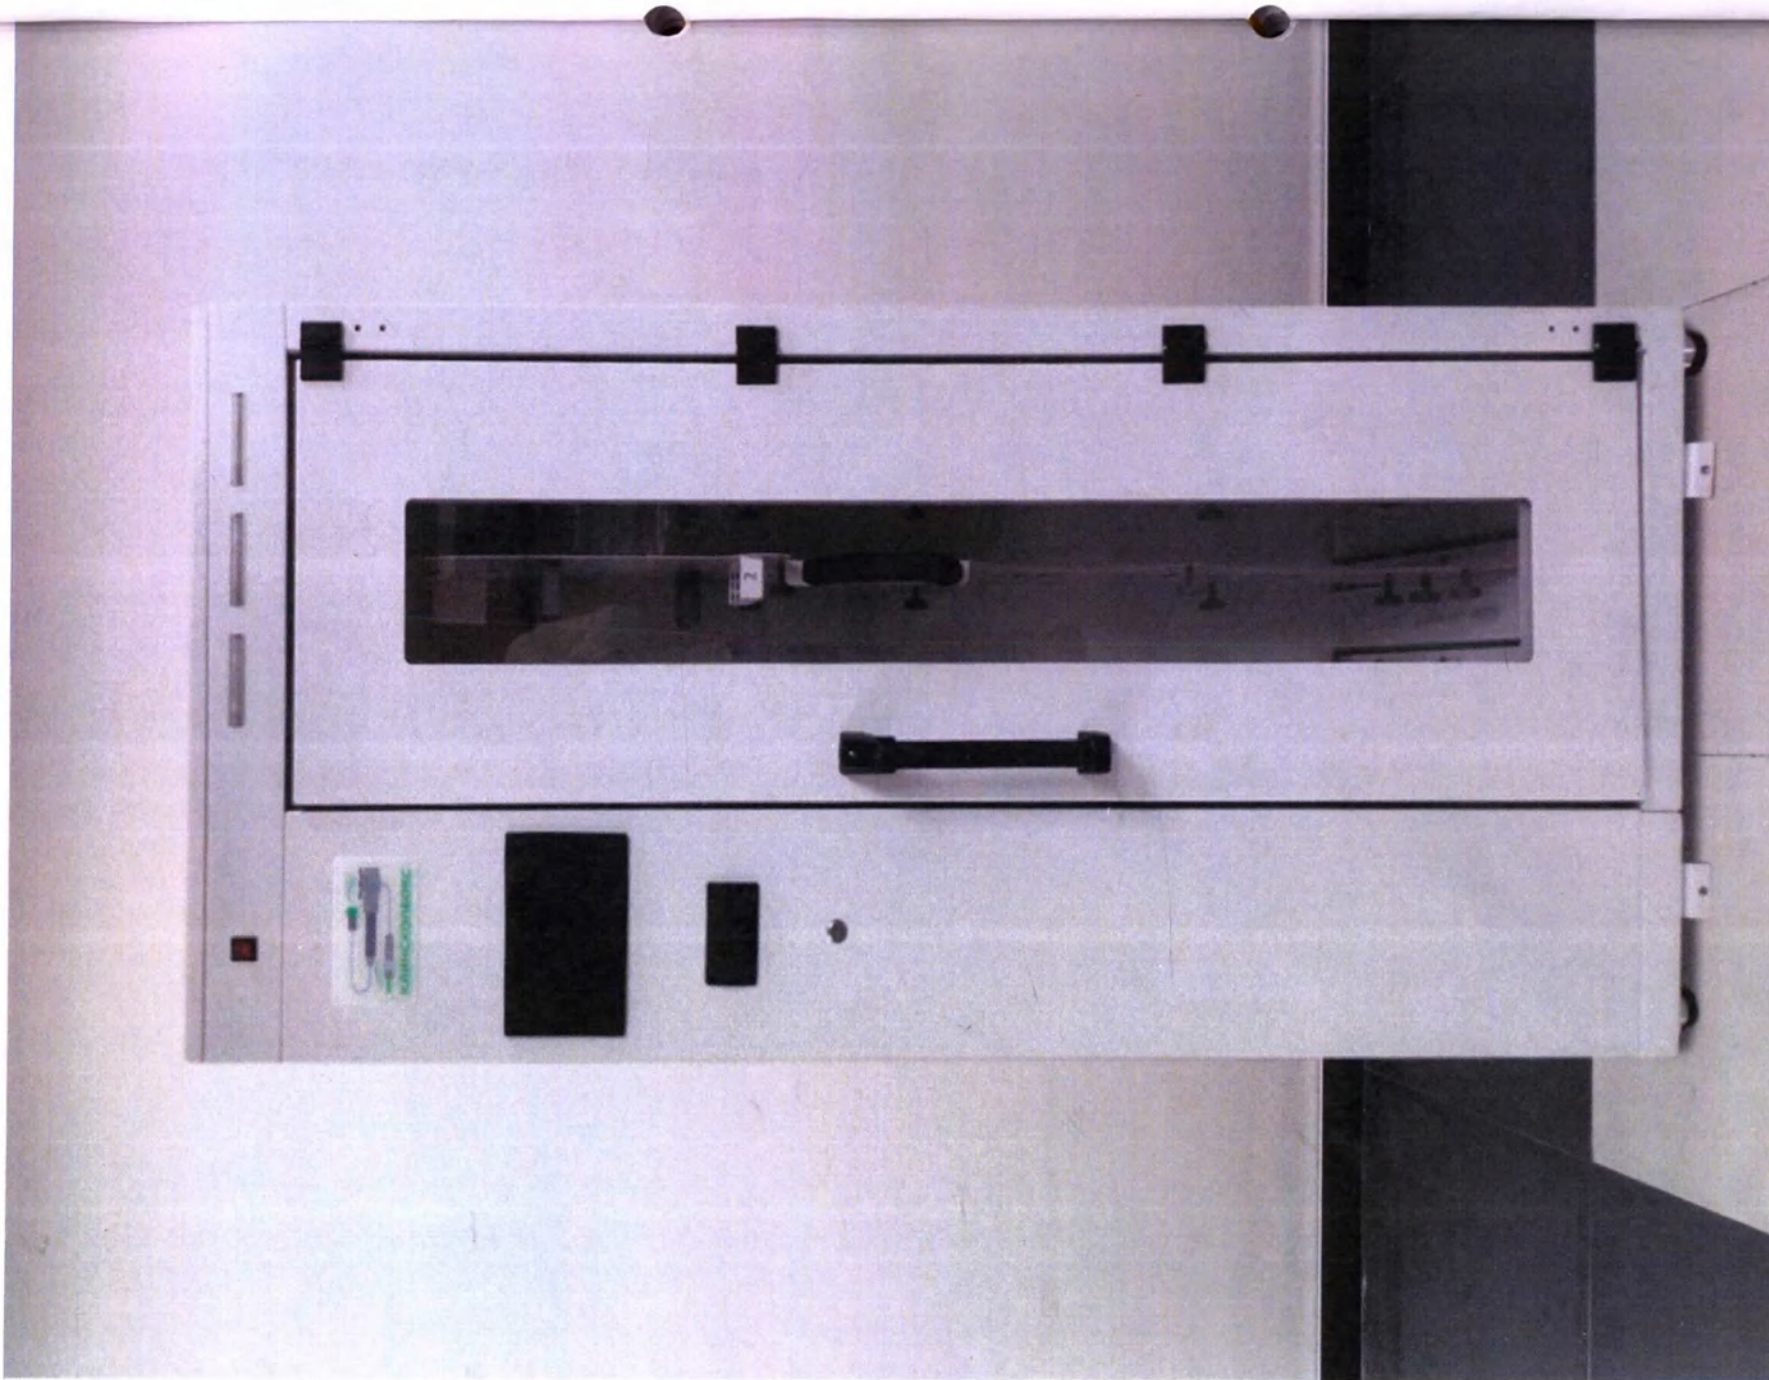

Фотографическое изображение №1. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Вид Шкафа спереди.

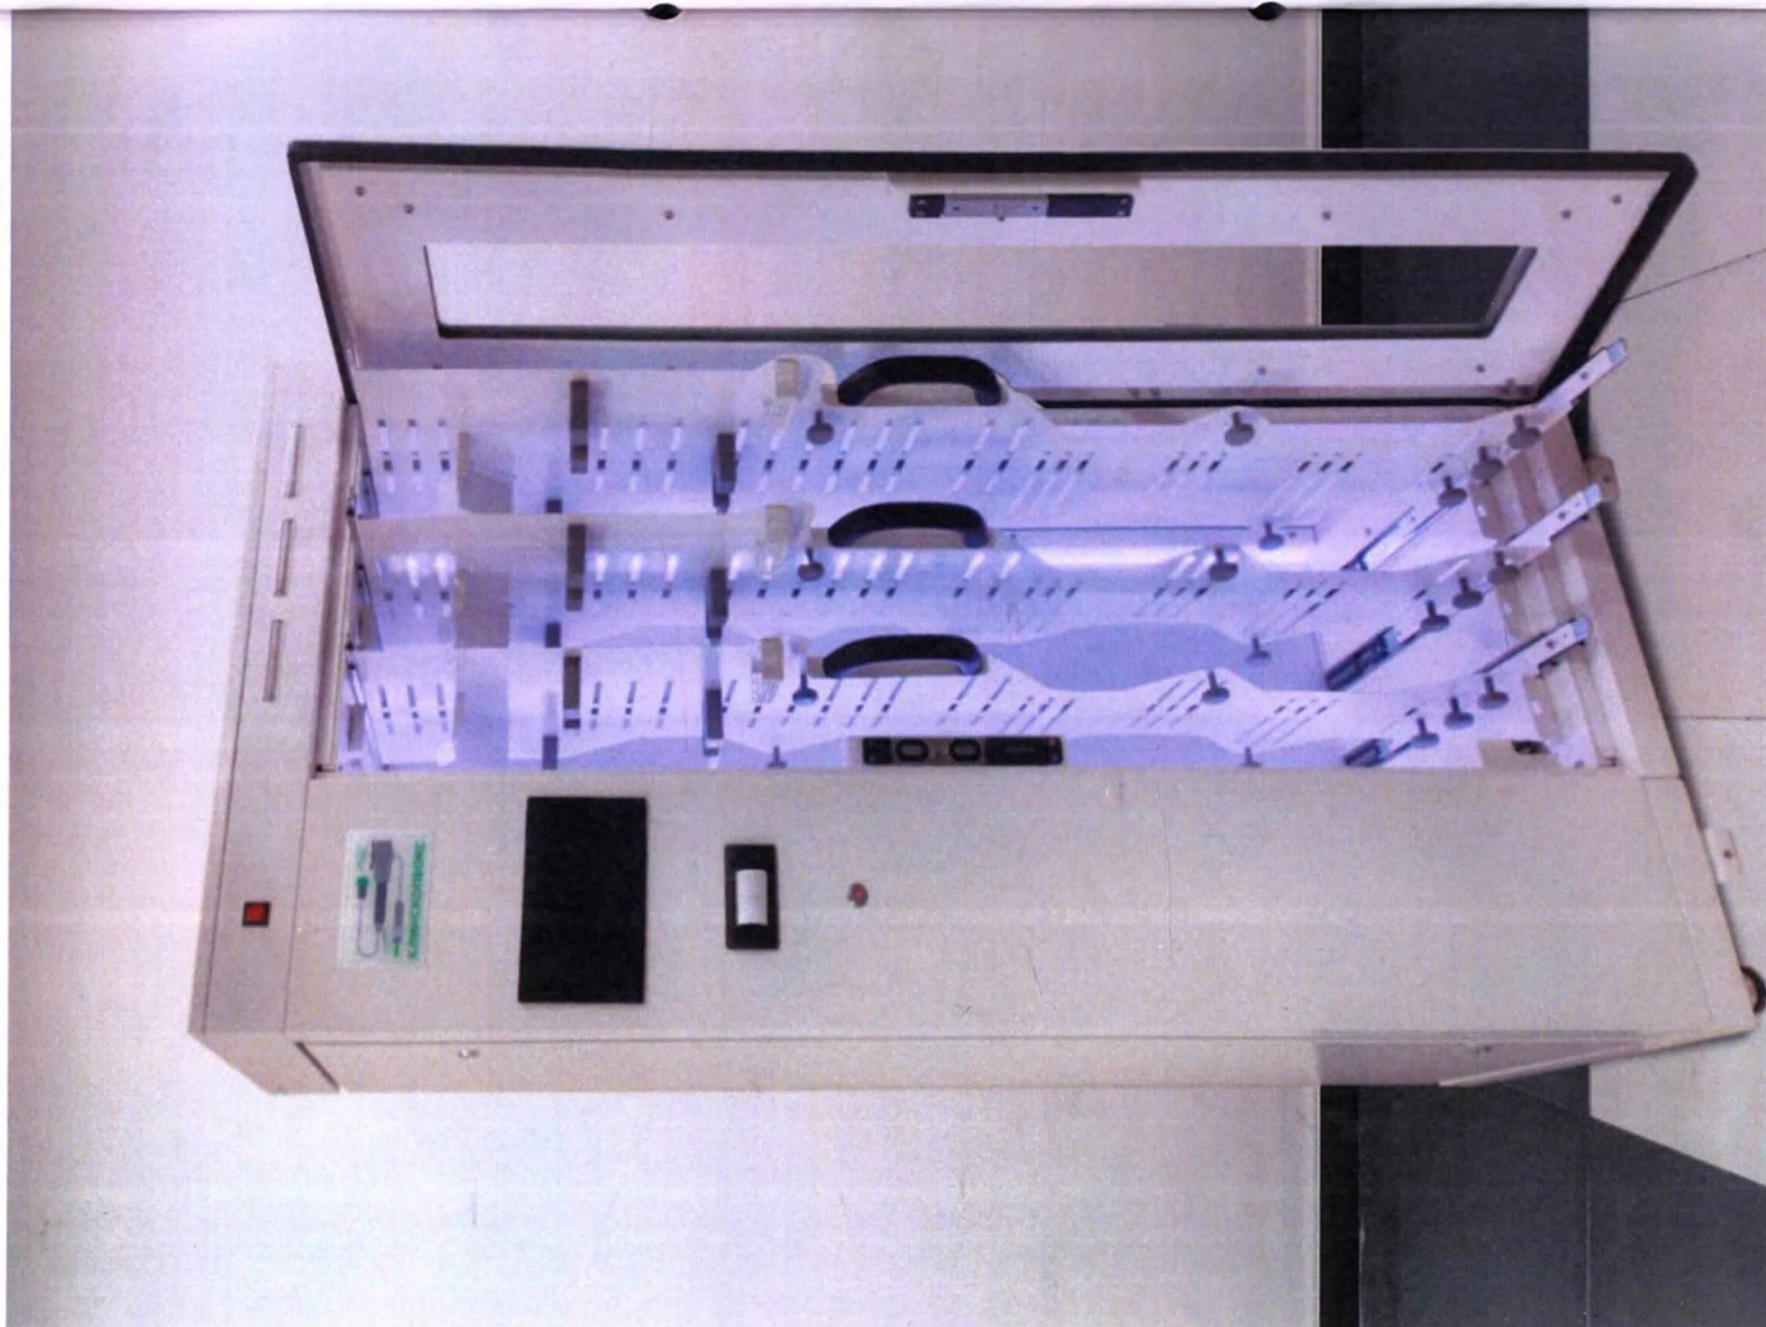

Фотографическое изображение №2. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3.Открыта дверь отсека хранения.

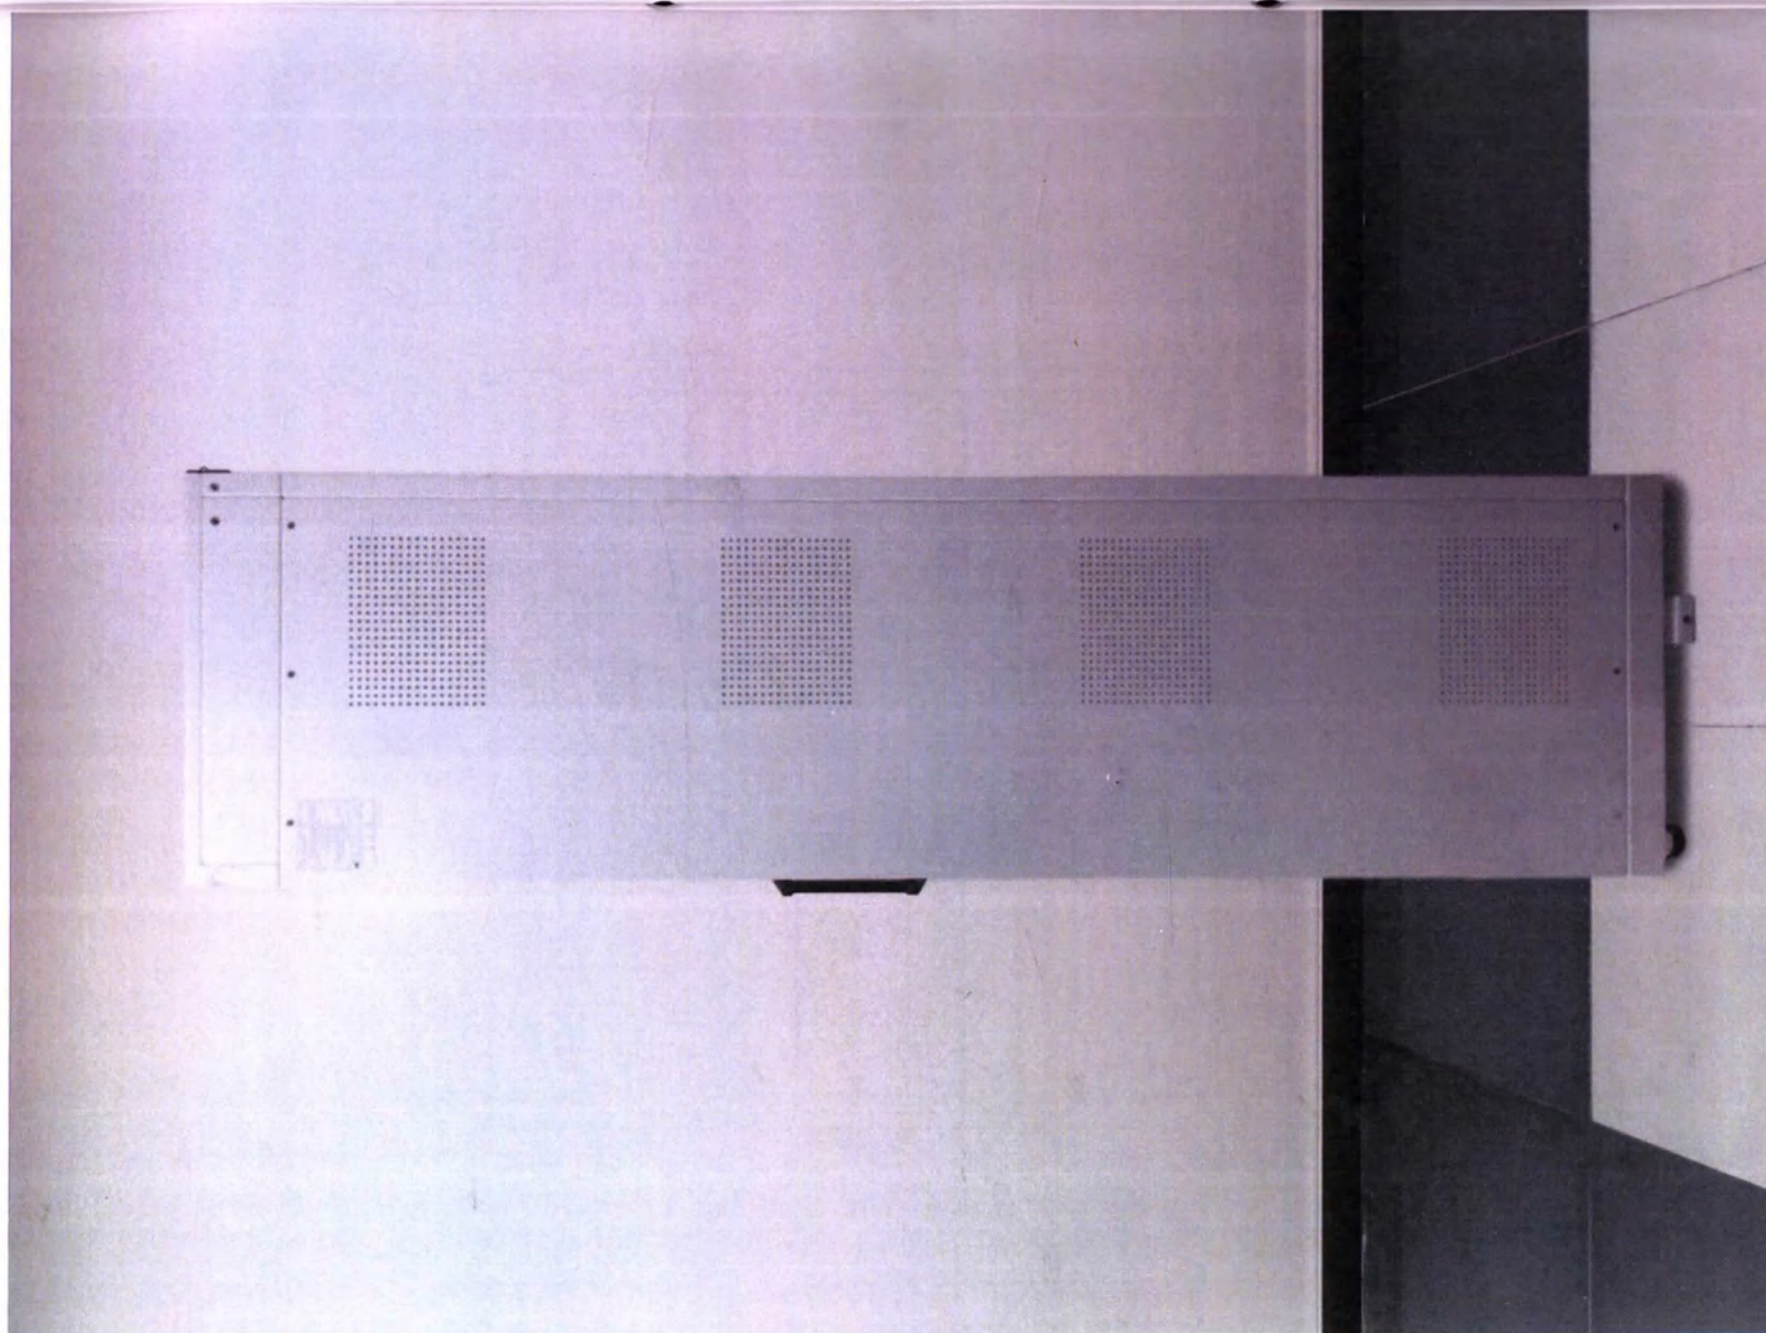

Фотографическое изображение №3. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Вид шкафа с правого бока.

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов
КЛИНСКОПБОКС
серия 4002
 000001

Дифракционное решение хранения гибких эндоскопов в асептической среде

Вариант исполнения	КЛИНСКОПБОКС-3
Напряжение, В/Частота, Гц	~ 230/50
Мощность, Вт	185
Степень защиты	IP10
Масса, кг	160
Габариты (ШхГхВ), мм	820х591х1958,50
Дата изготовления	07.2023г.
Сборщик	Санталип Р.З.

ТУ 12.50.50-601-40718084-2023

Производитель: ООО "ЦДГ", Россия, 111034, г. Москва, ул. 5-я Кабельная
 д.2, стр.6, пом. 20. Тел.: +7-991-591-77-97, эл. почта: cdg.msk@yandex.ru

Место производства: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Монтажных д.8

Условия эксплуатации при температуре от +10 до +40 °С, влажность до 80%.

Исходящее изделие утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
 от " " 20 года


RU 146

↑↑


⊗

📖


Фотографическое изображение №4. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Маркировка Шкафа.

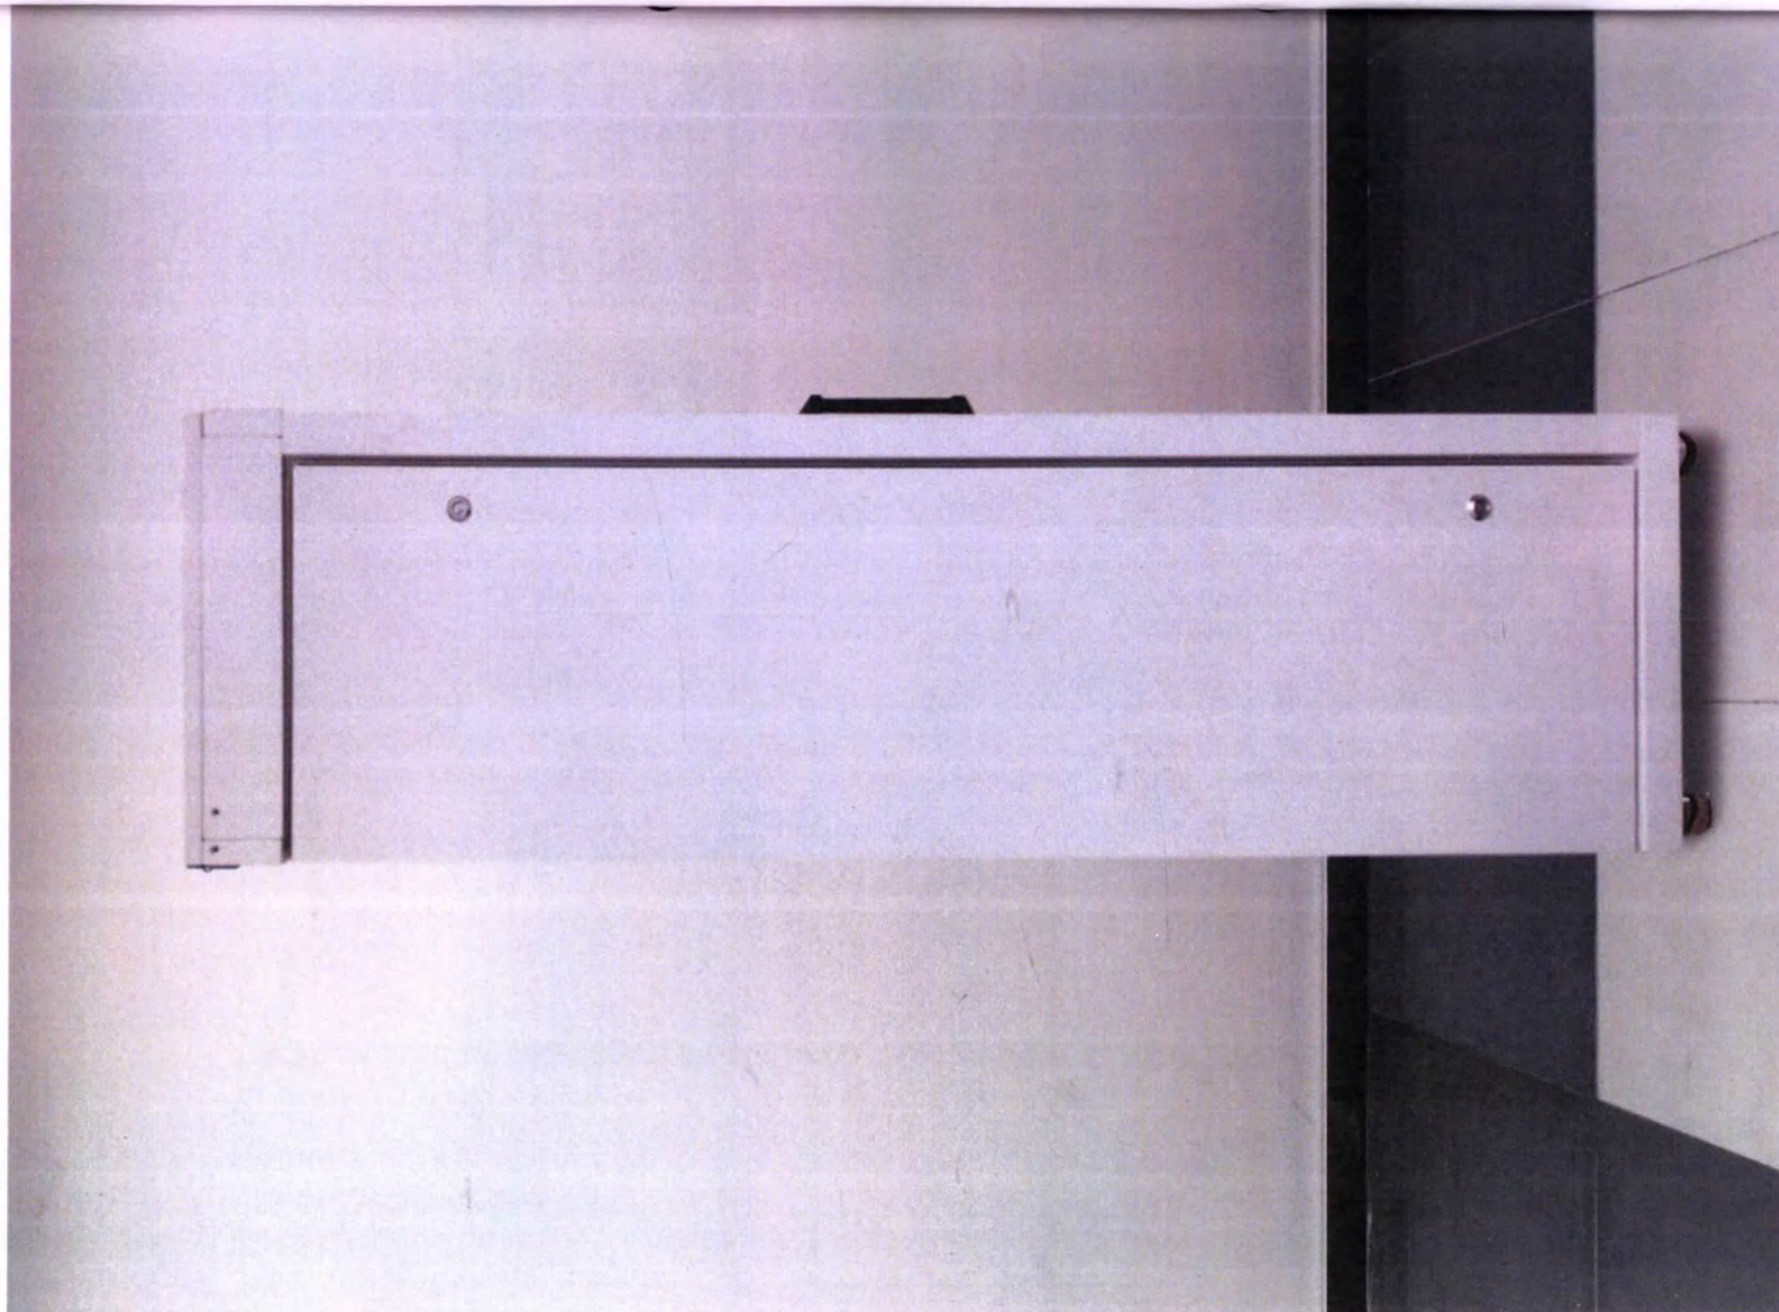


Фотографическое изображение №5. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Вид Шкафа с левого бока.

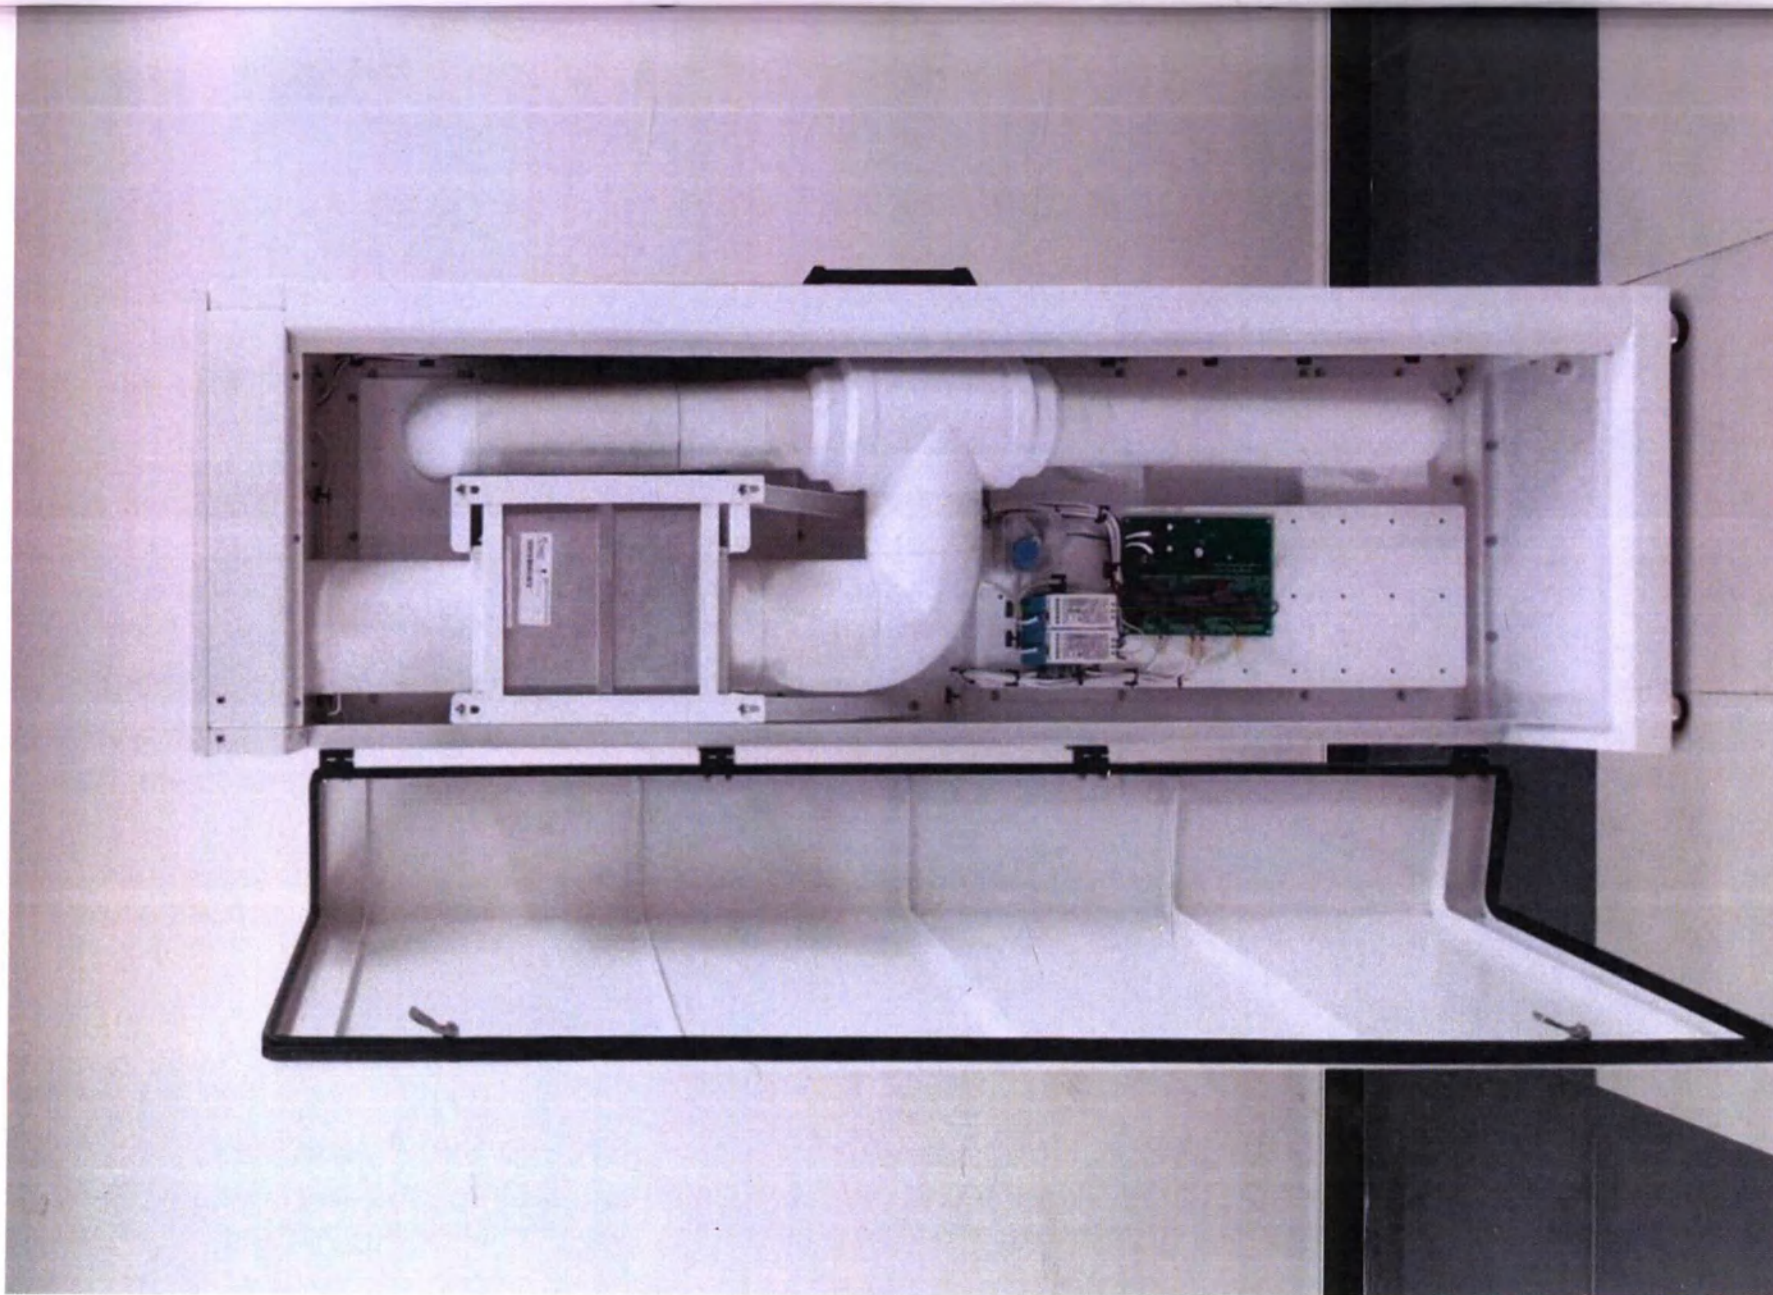

Фотографическое изображение №6. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Открыта дверь бокового технического отсека.

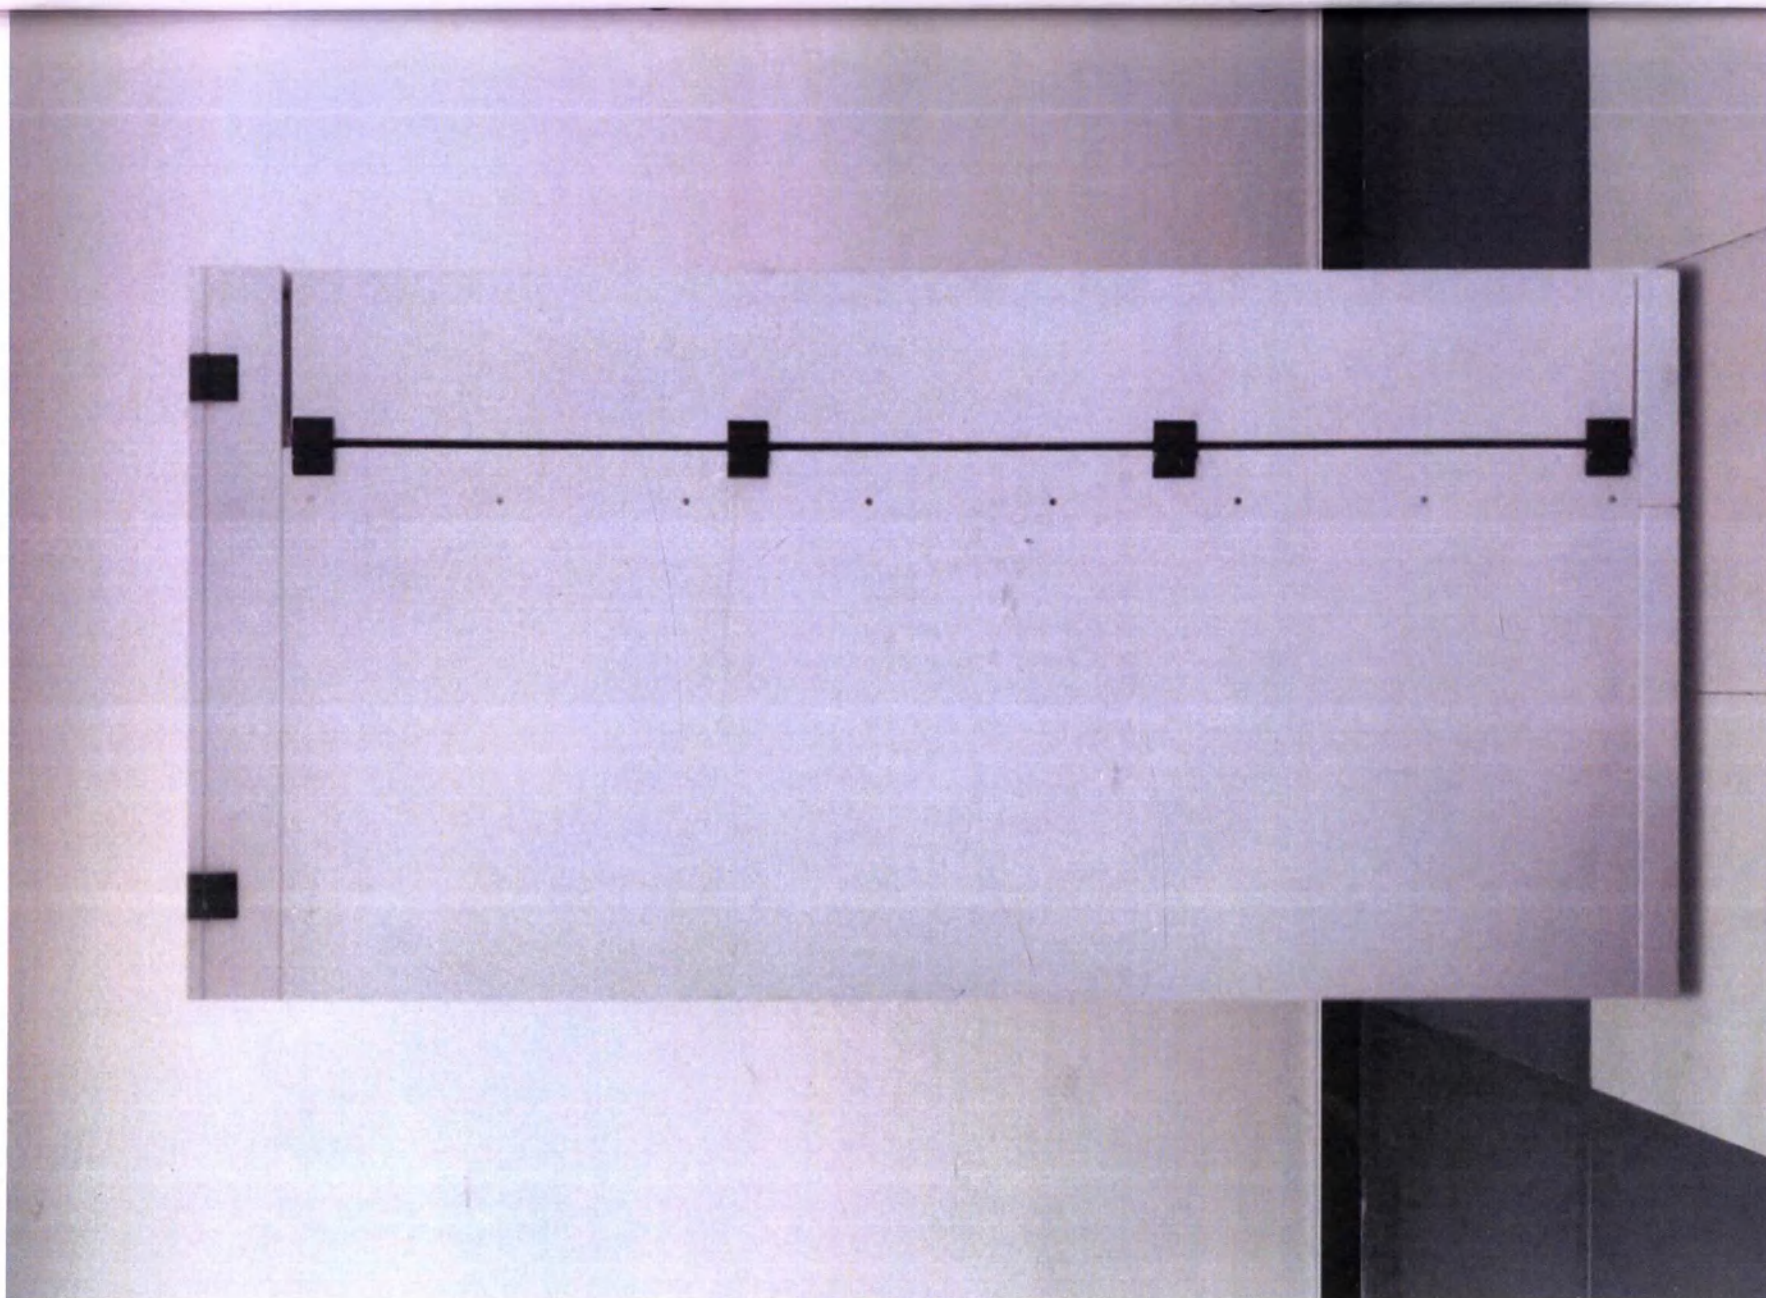


Фотографическое изображение №7. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Задняя стенка Шкафа.

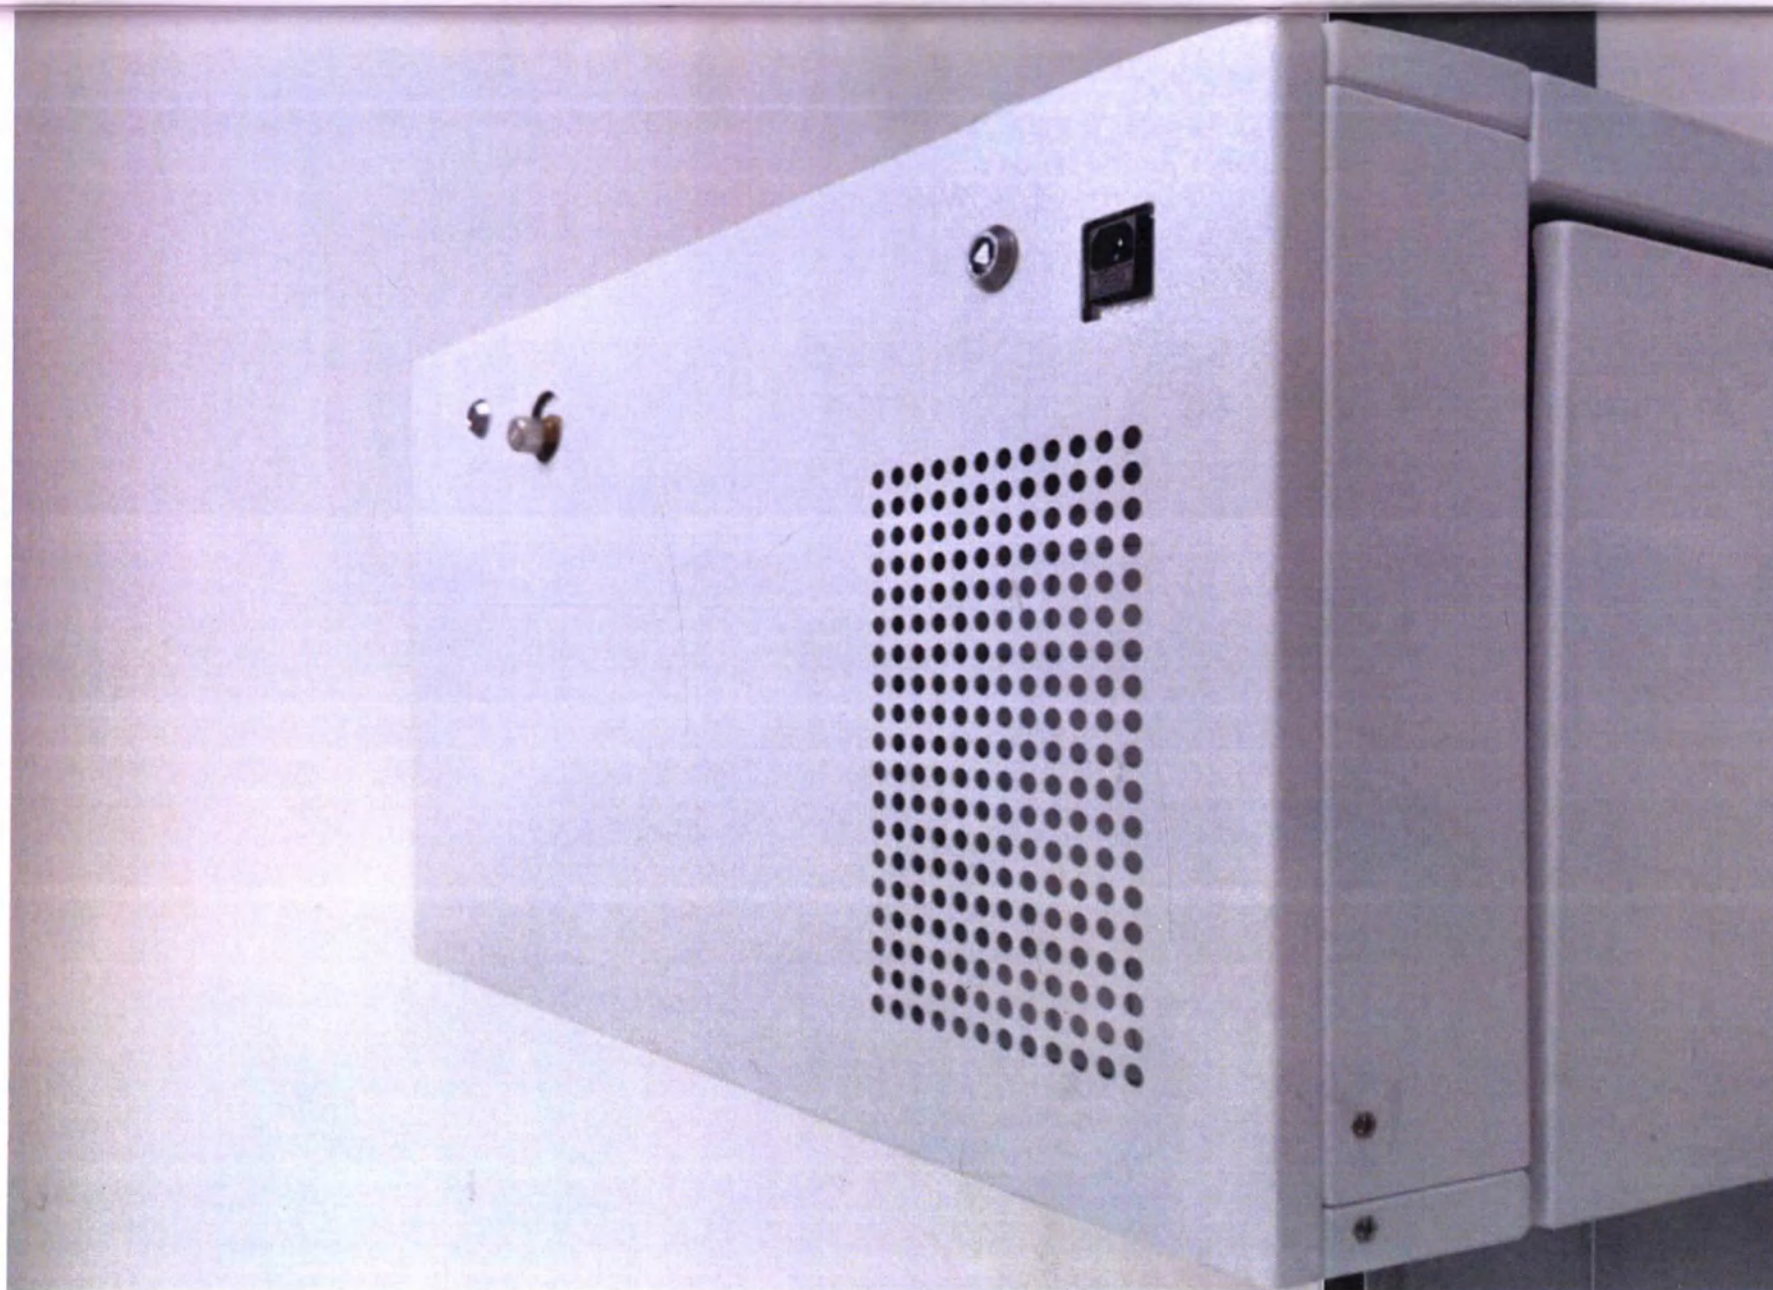


Фотографическое изображение №8. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Верхняя крышка технического отсека.




Фотографическое изображение №9. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-3. Открыта верхняя крышка технического отсека.

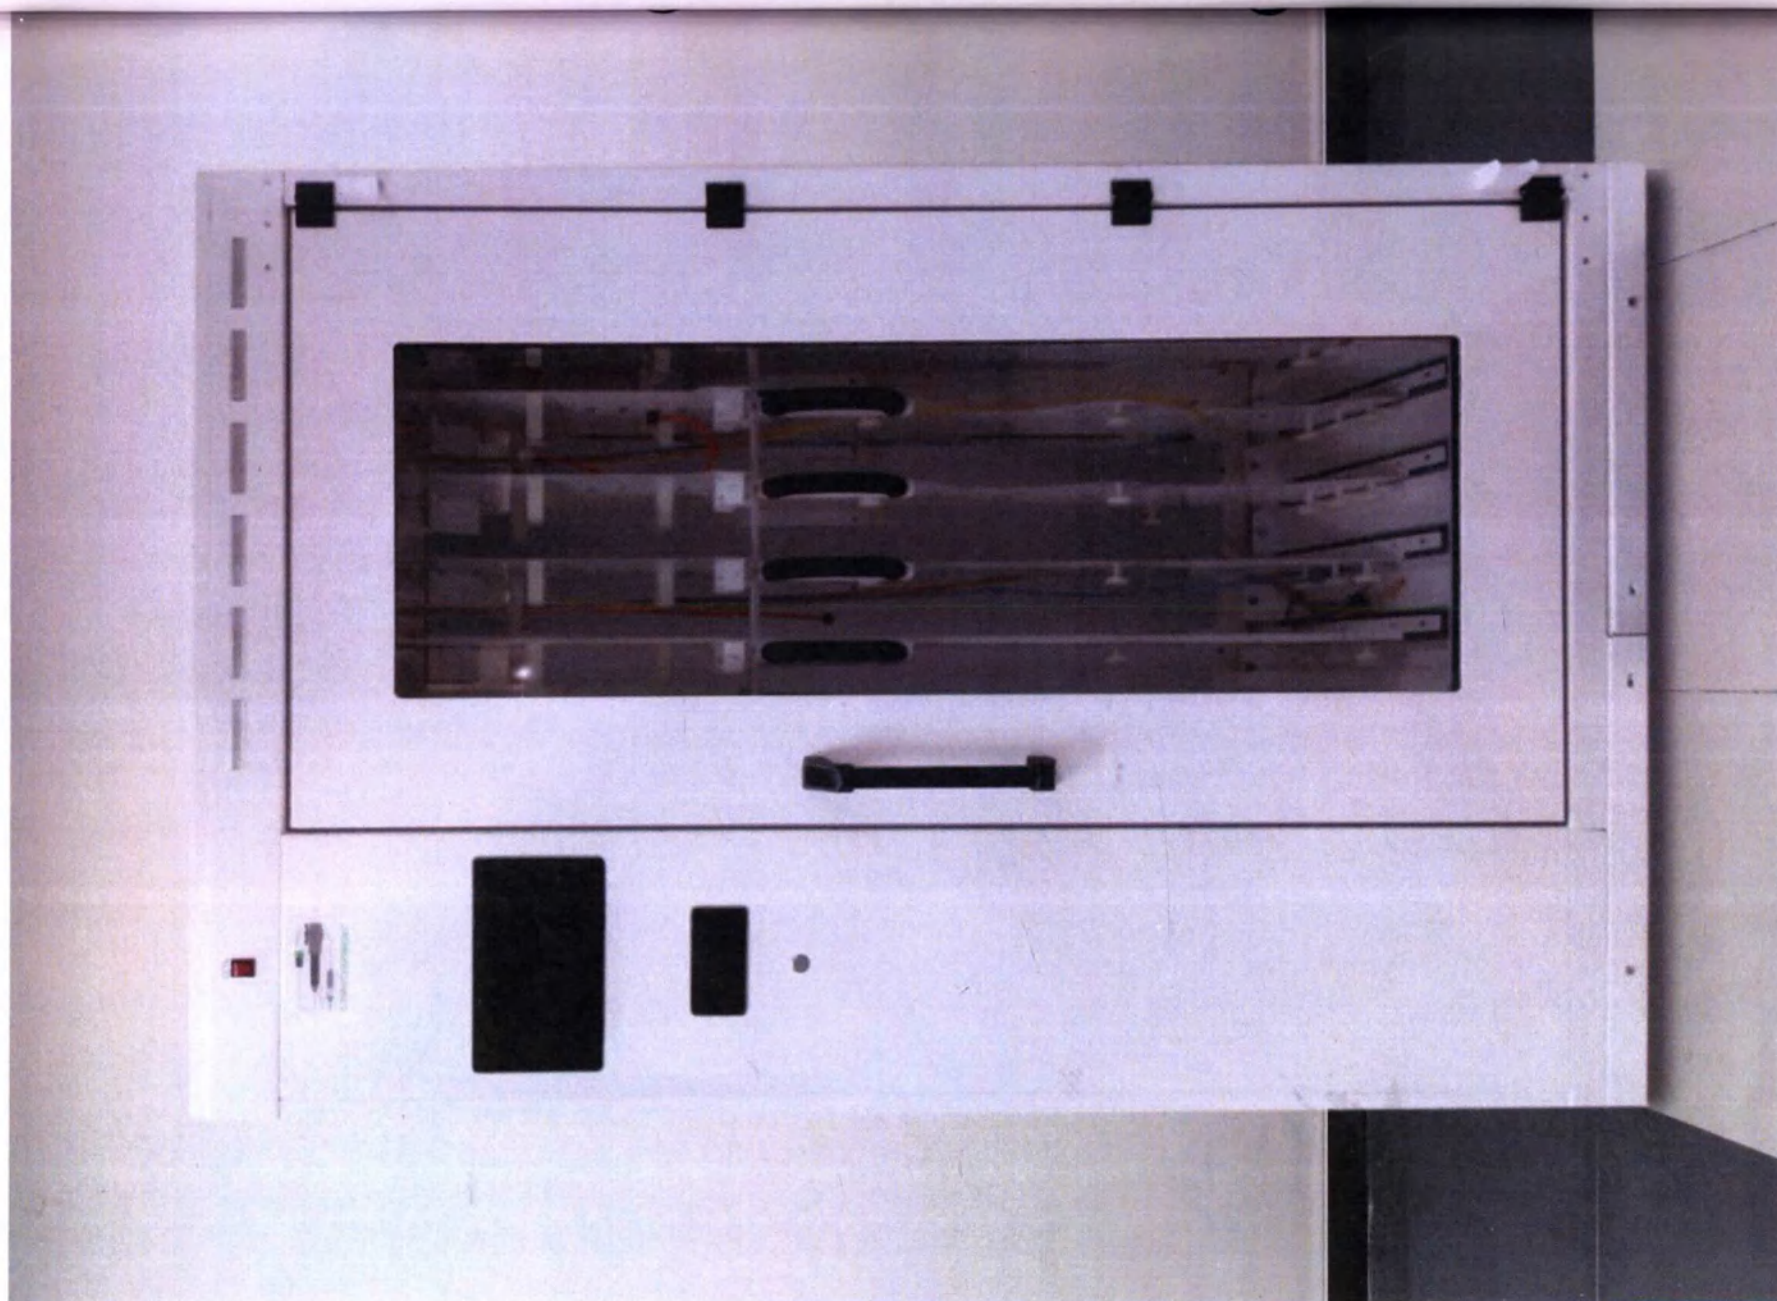

Фотографическое изображение №10. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Вид Шкафа спереди.

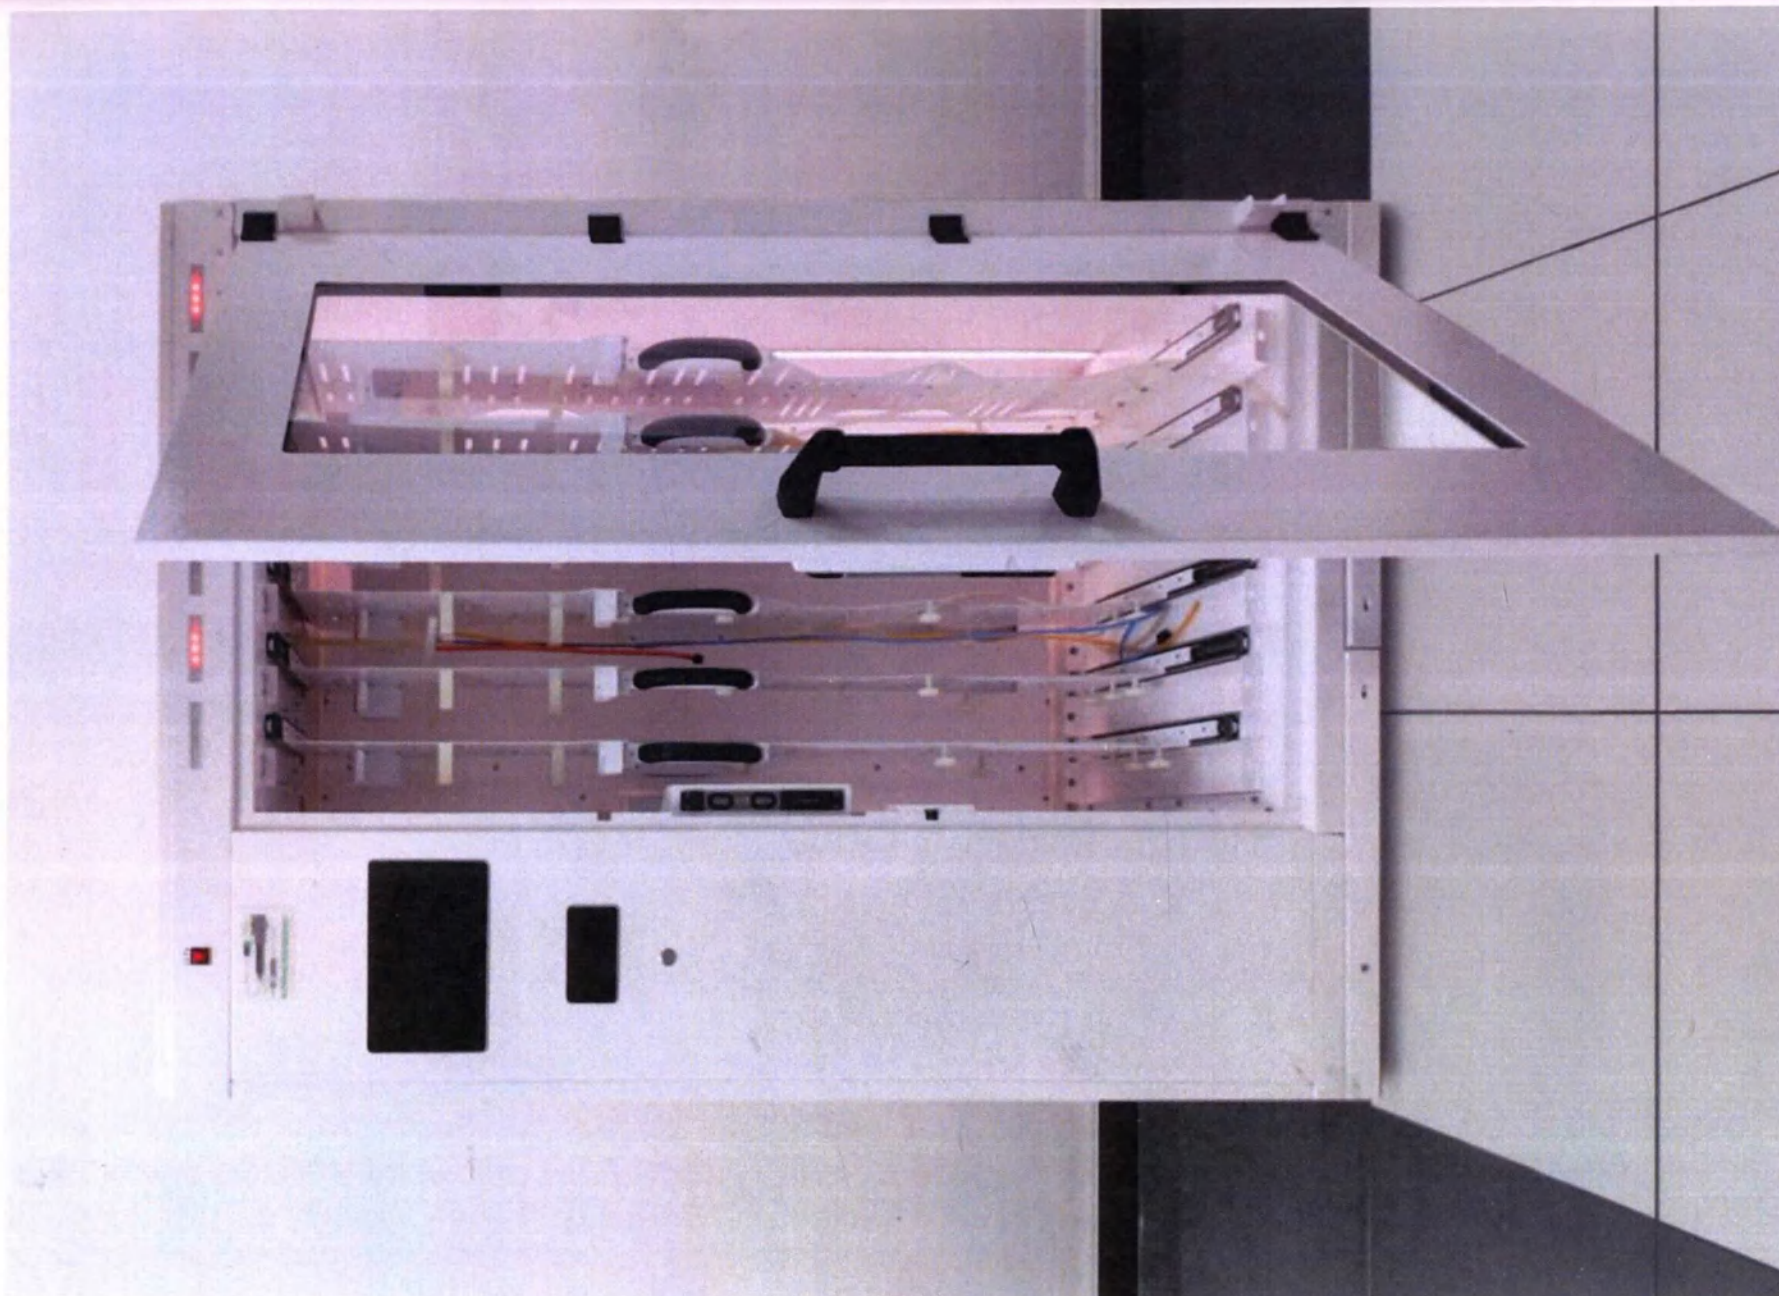

Фотографическое изображение №11. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Открыта дверь отсека хранения.

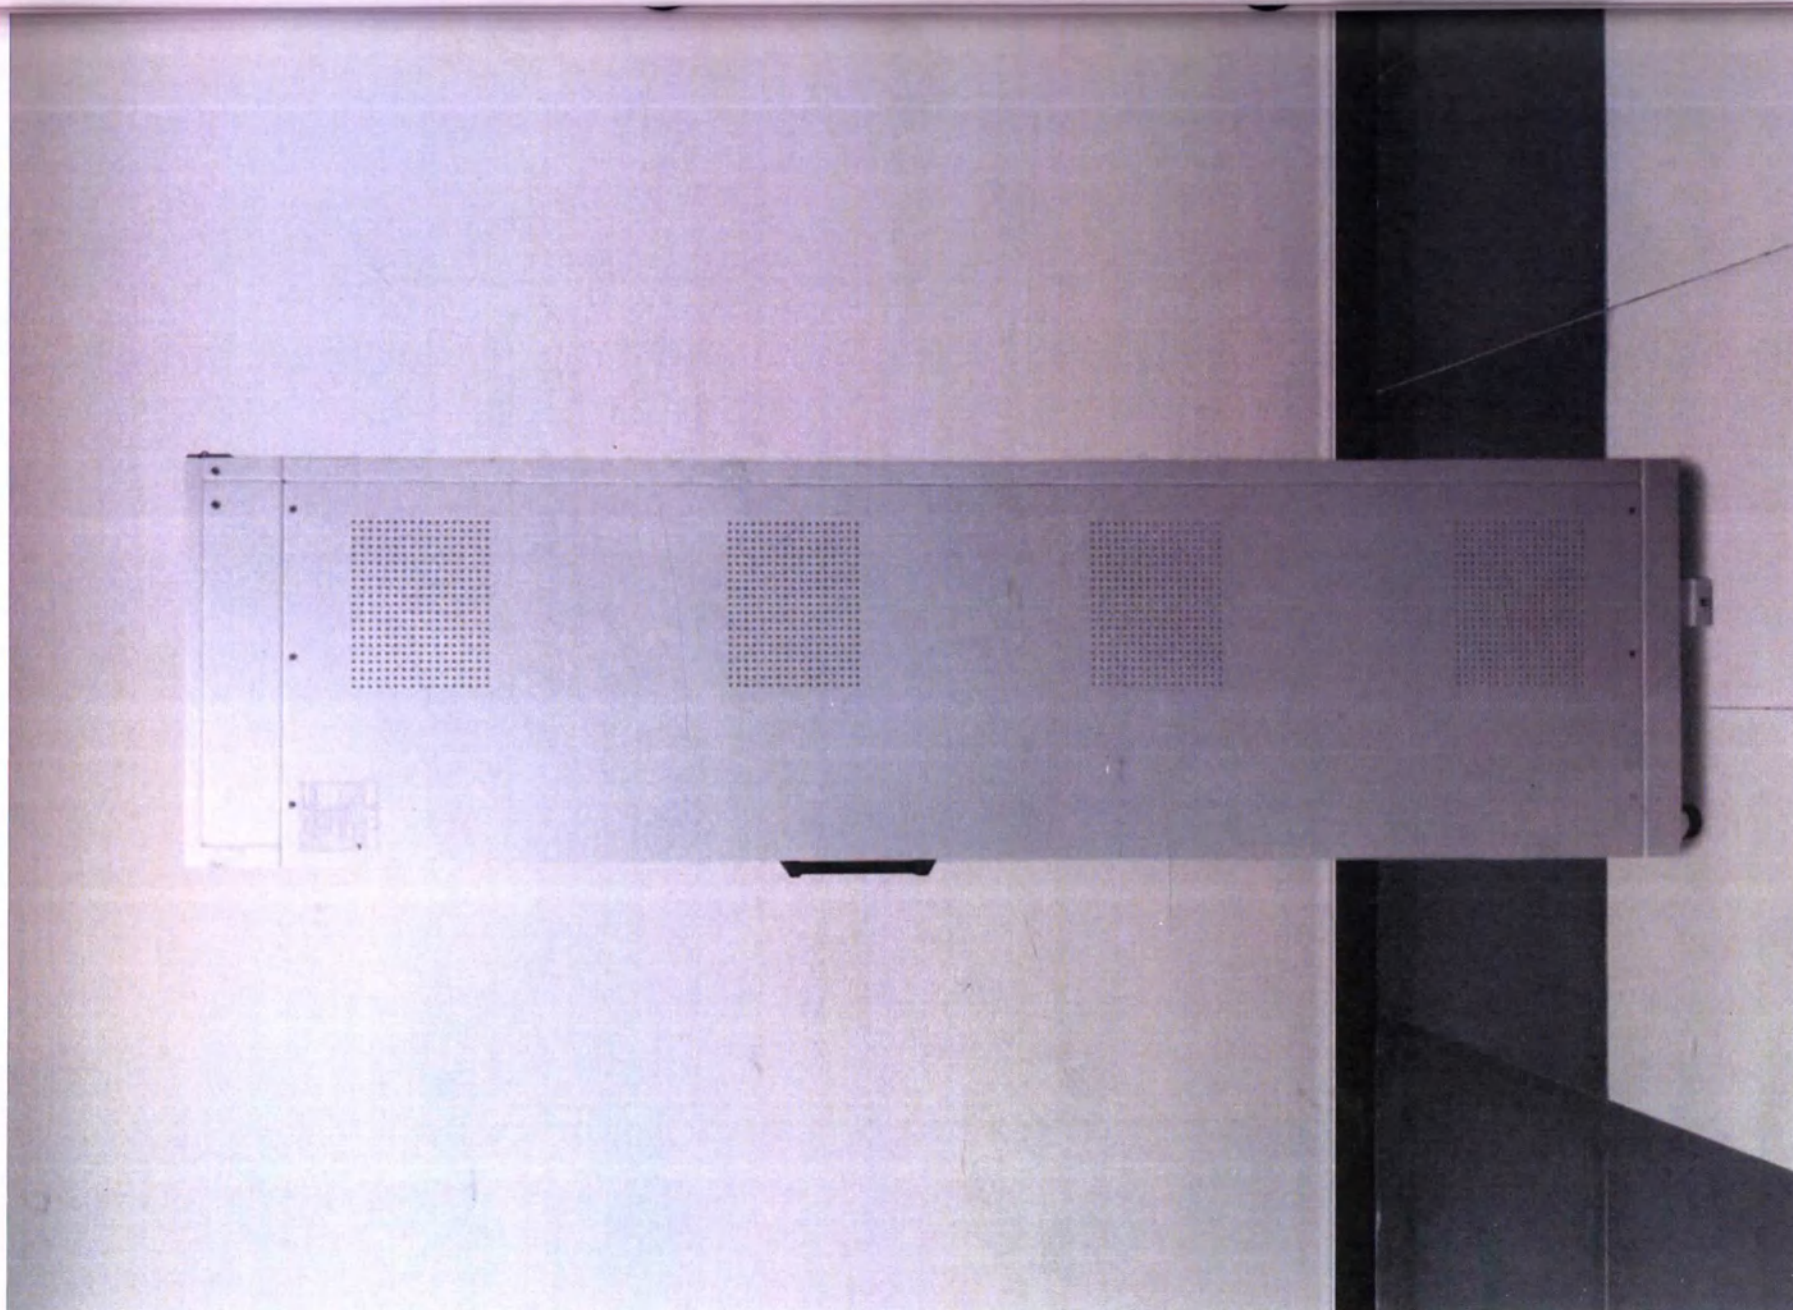

Фотографическое изображение №12. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Вид шкафа с правого бока.

Фотографическое изображение №13. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Маркировка Шкафа.

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов

КЛИНСКОПБОКС

00002

Эффективное решение хранения гибких эндоскопов в асептической среде

Вариант исполнения	КЛИНСКОПБОКС-6
Напряжение, В/Частота, Гц	~230/50
Мощность, Вт	240
Степень защиты	IP10
Масса, кг	210
Габариты (ШхГхВ), мм	1210х591х1958,50
Дата изготовления	07.2023г.
Сборщик	Сайтгалин Р.З.

ТУ 12.50.50-001-40718084-2023


 Производители: ООО "ЦИРМ", Россия, 111104, г. Москва, ул. 5-я Кабельная д.2, стр.6, пом. 20. Тел: +7-991-591-77-97, эл. почта: cbg.msk@yandex.ru.


Место производства: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Монтяжников д.8.

Условия эксплуатации при температуре от +10 до +40 °С, влажность до 80%.
 Исходящее изделие утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


от " " 20 года






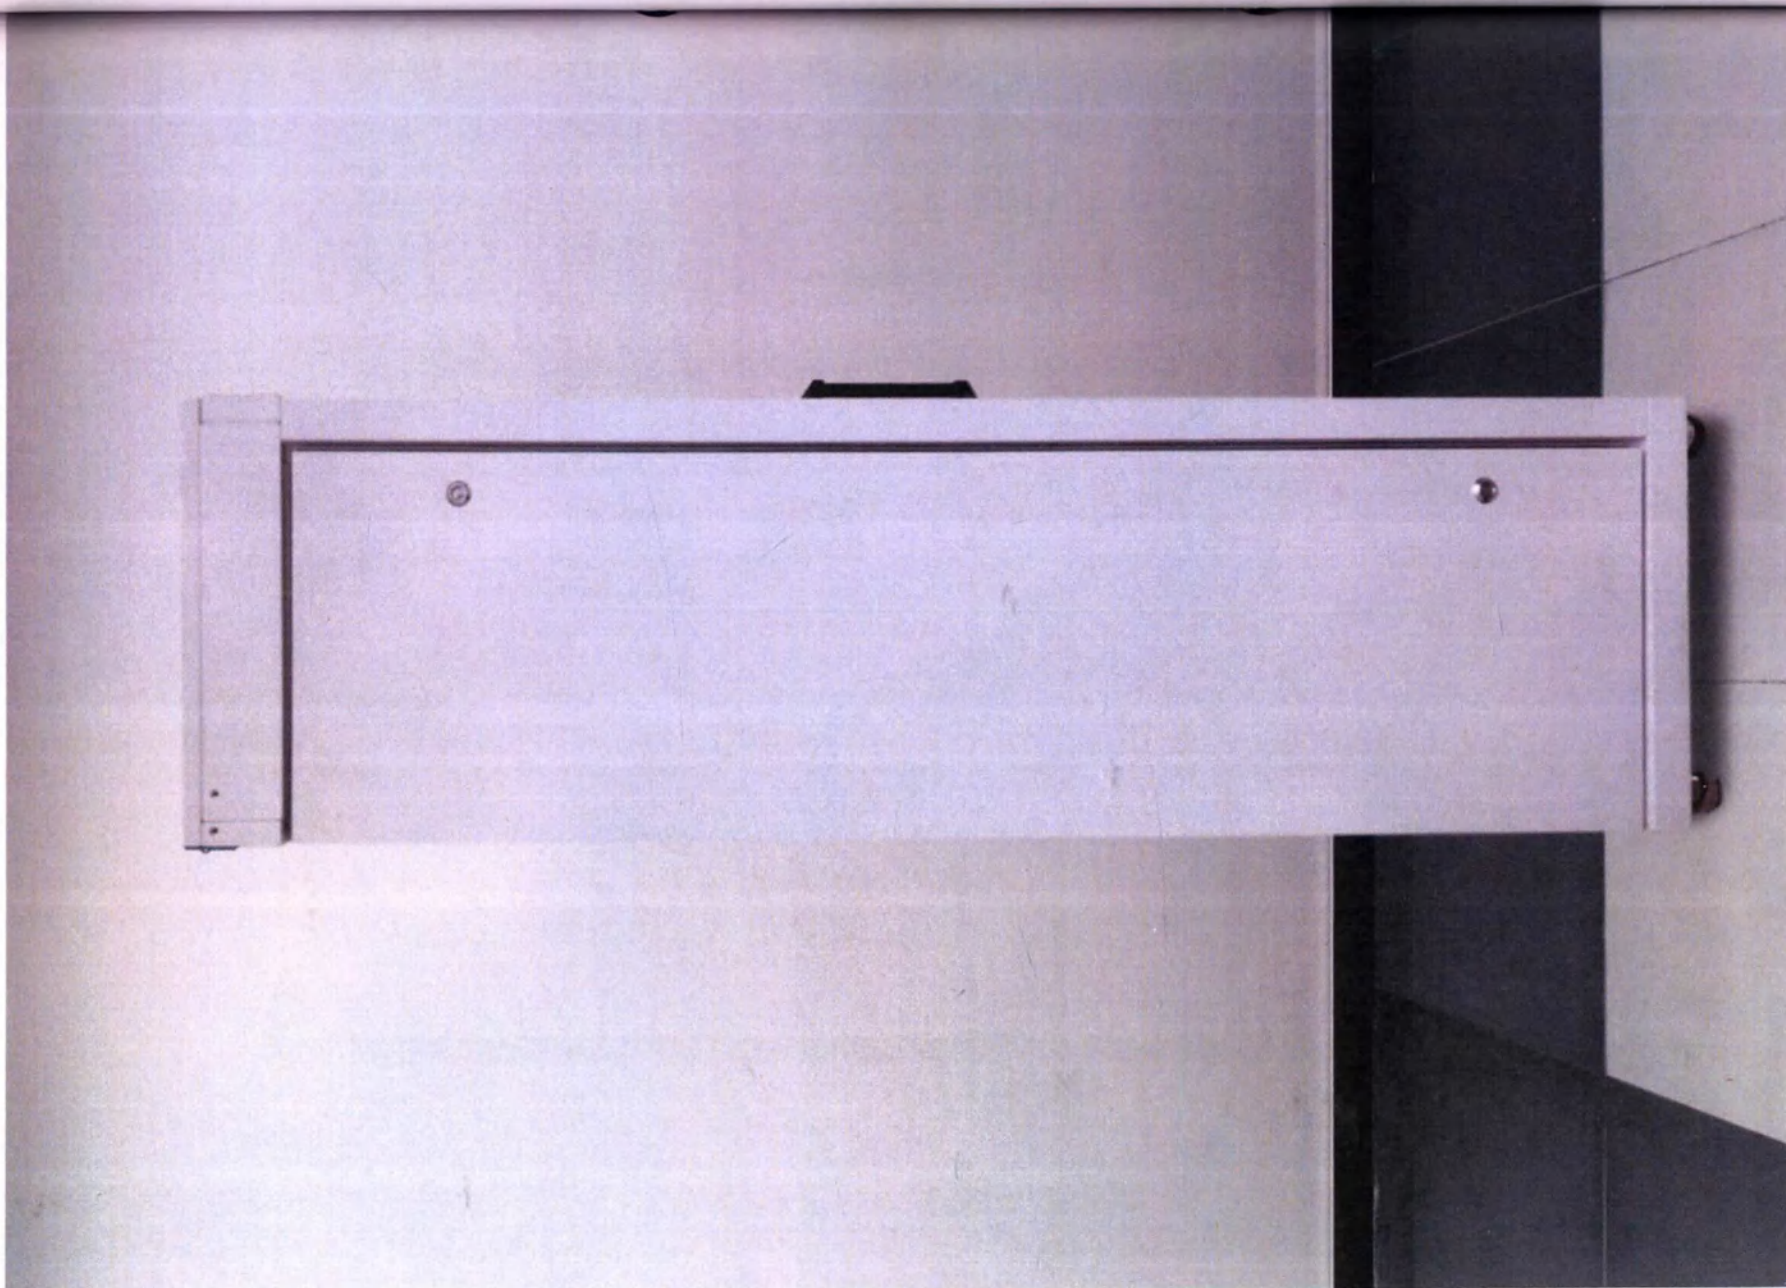


Фотографическое изображение №14. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Вид Шкафа с левого бока.

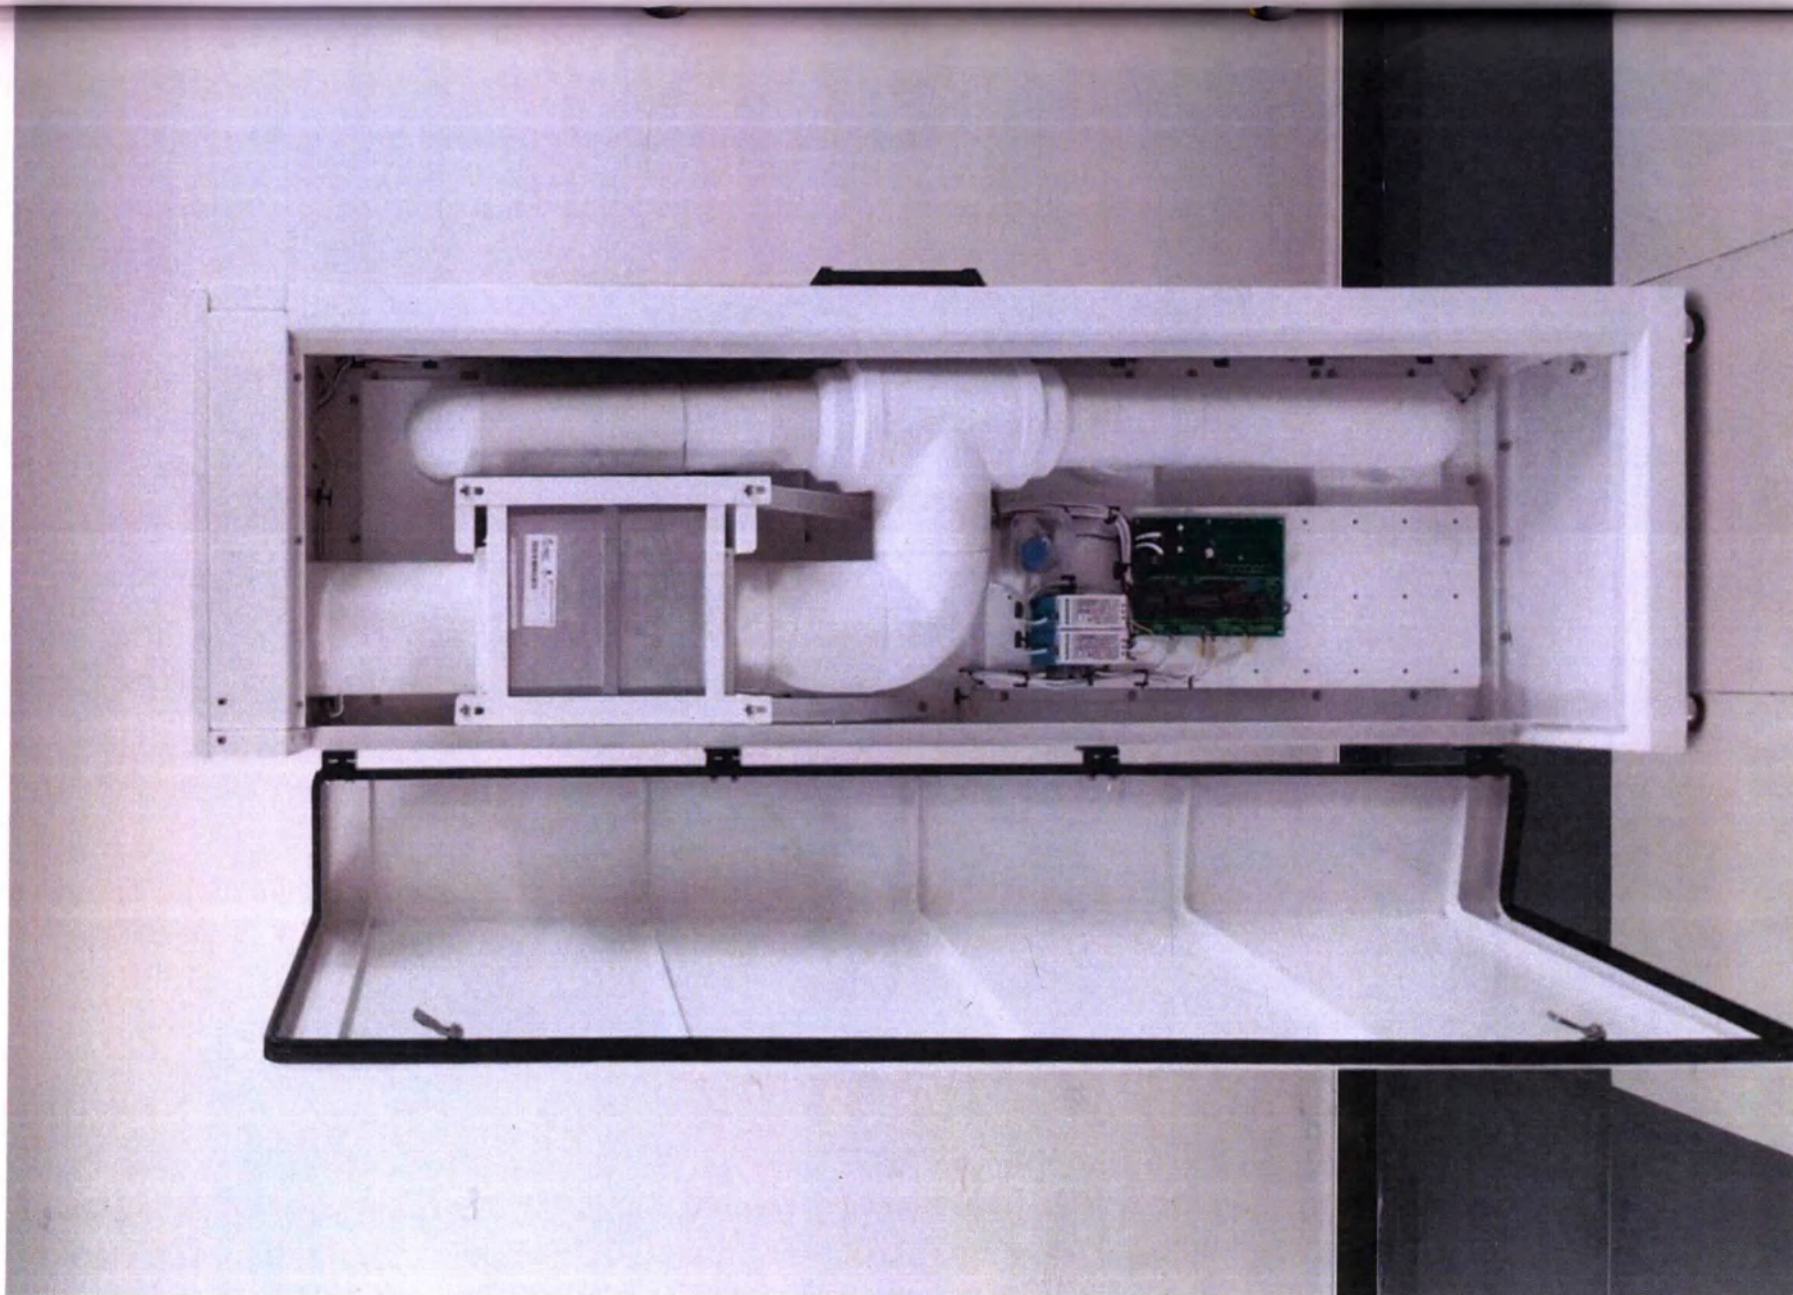


Фотографическое изображение №15. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Открыта дверь бокового технического отсека.

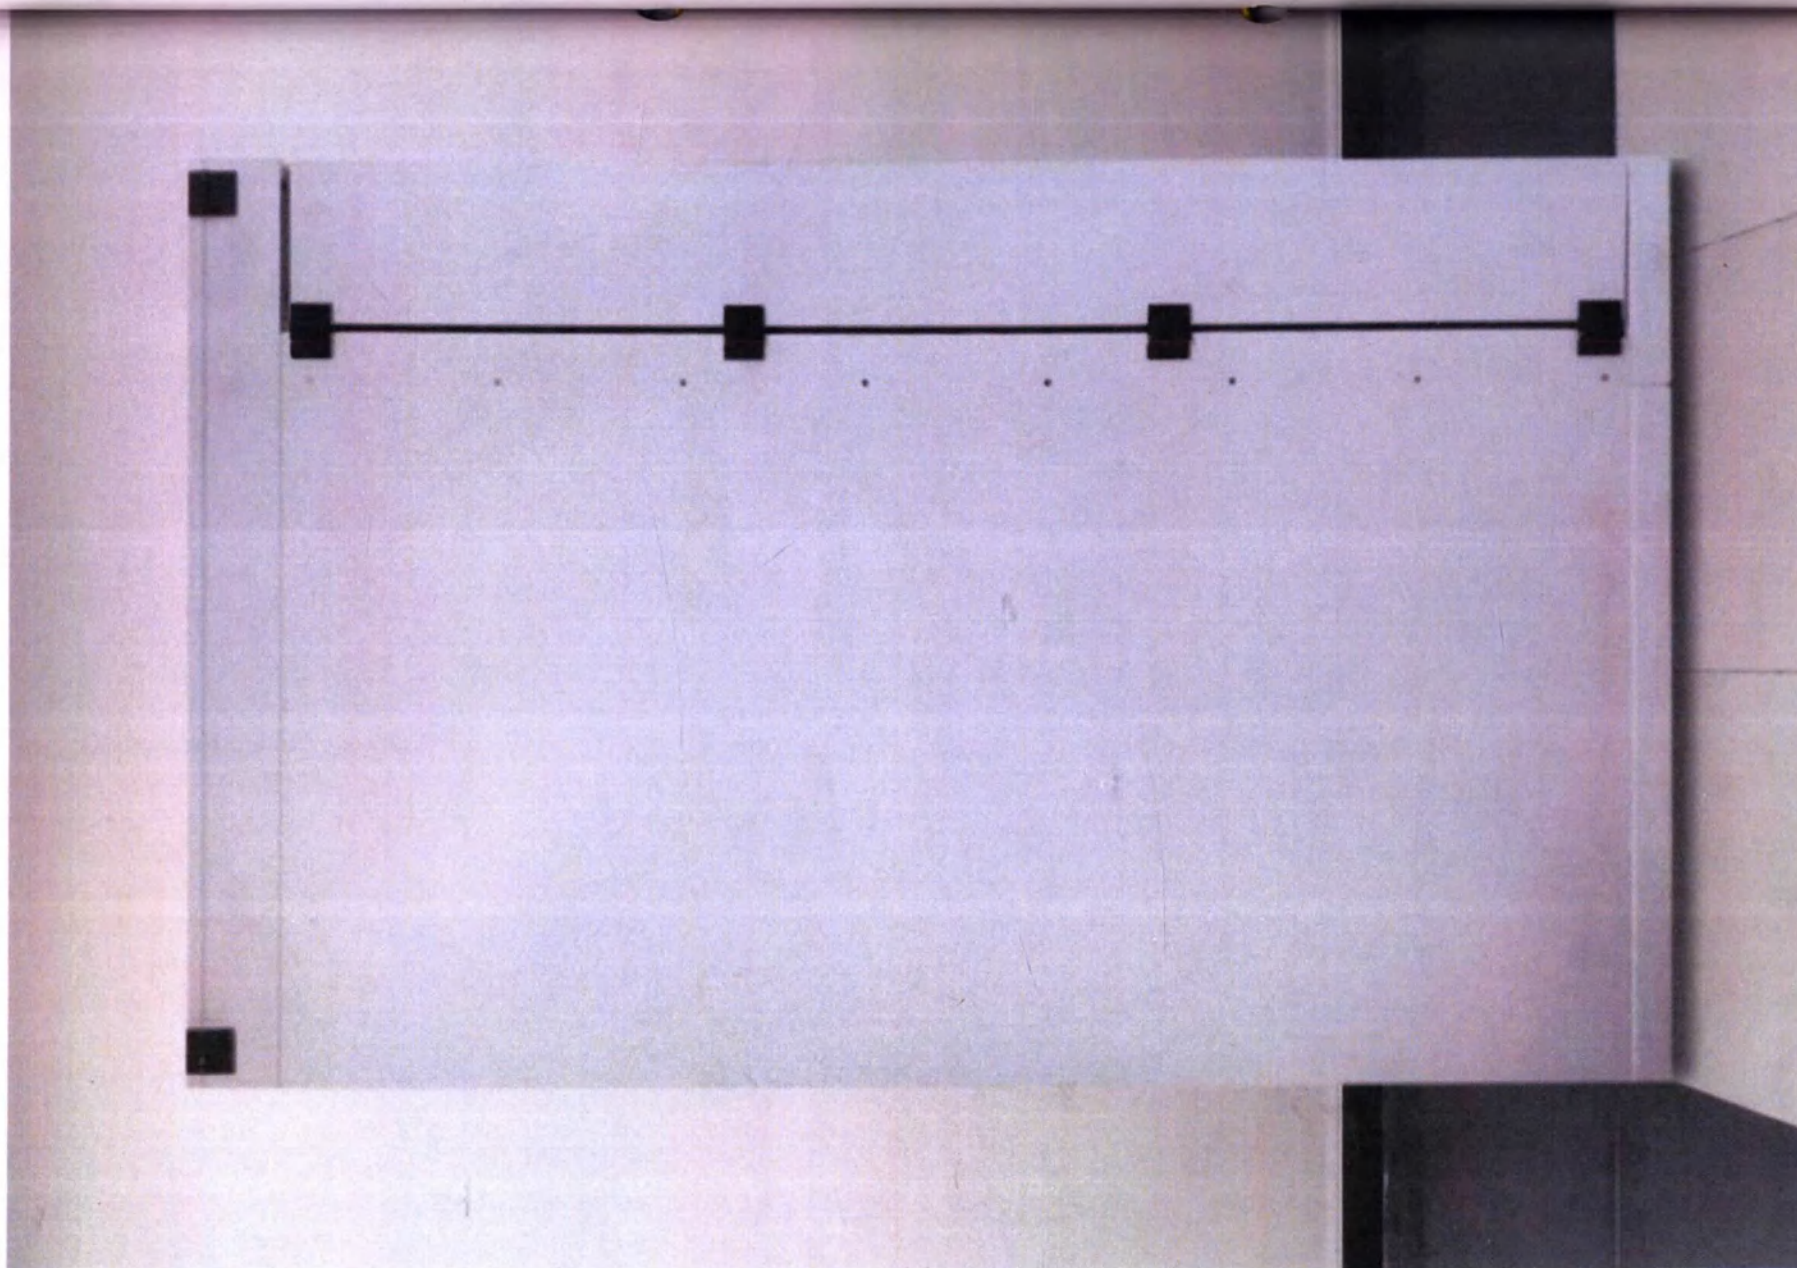


Фотографическое изображение №16. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Задняя стенка Шкафа.

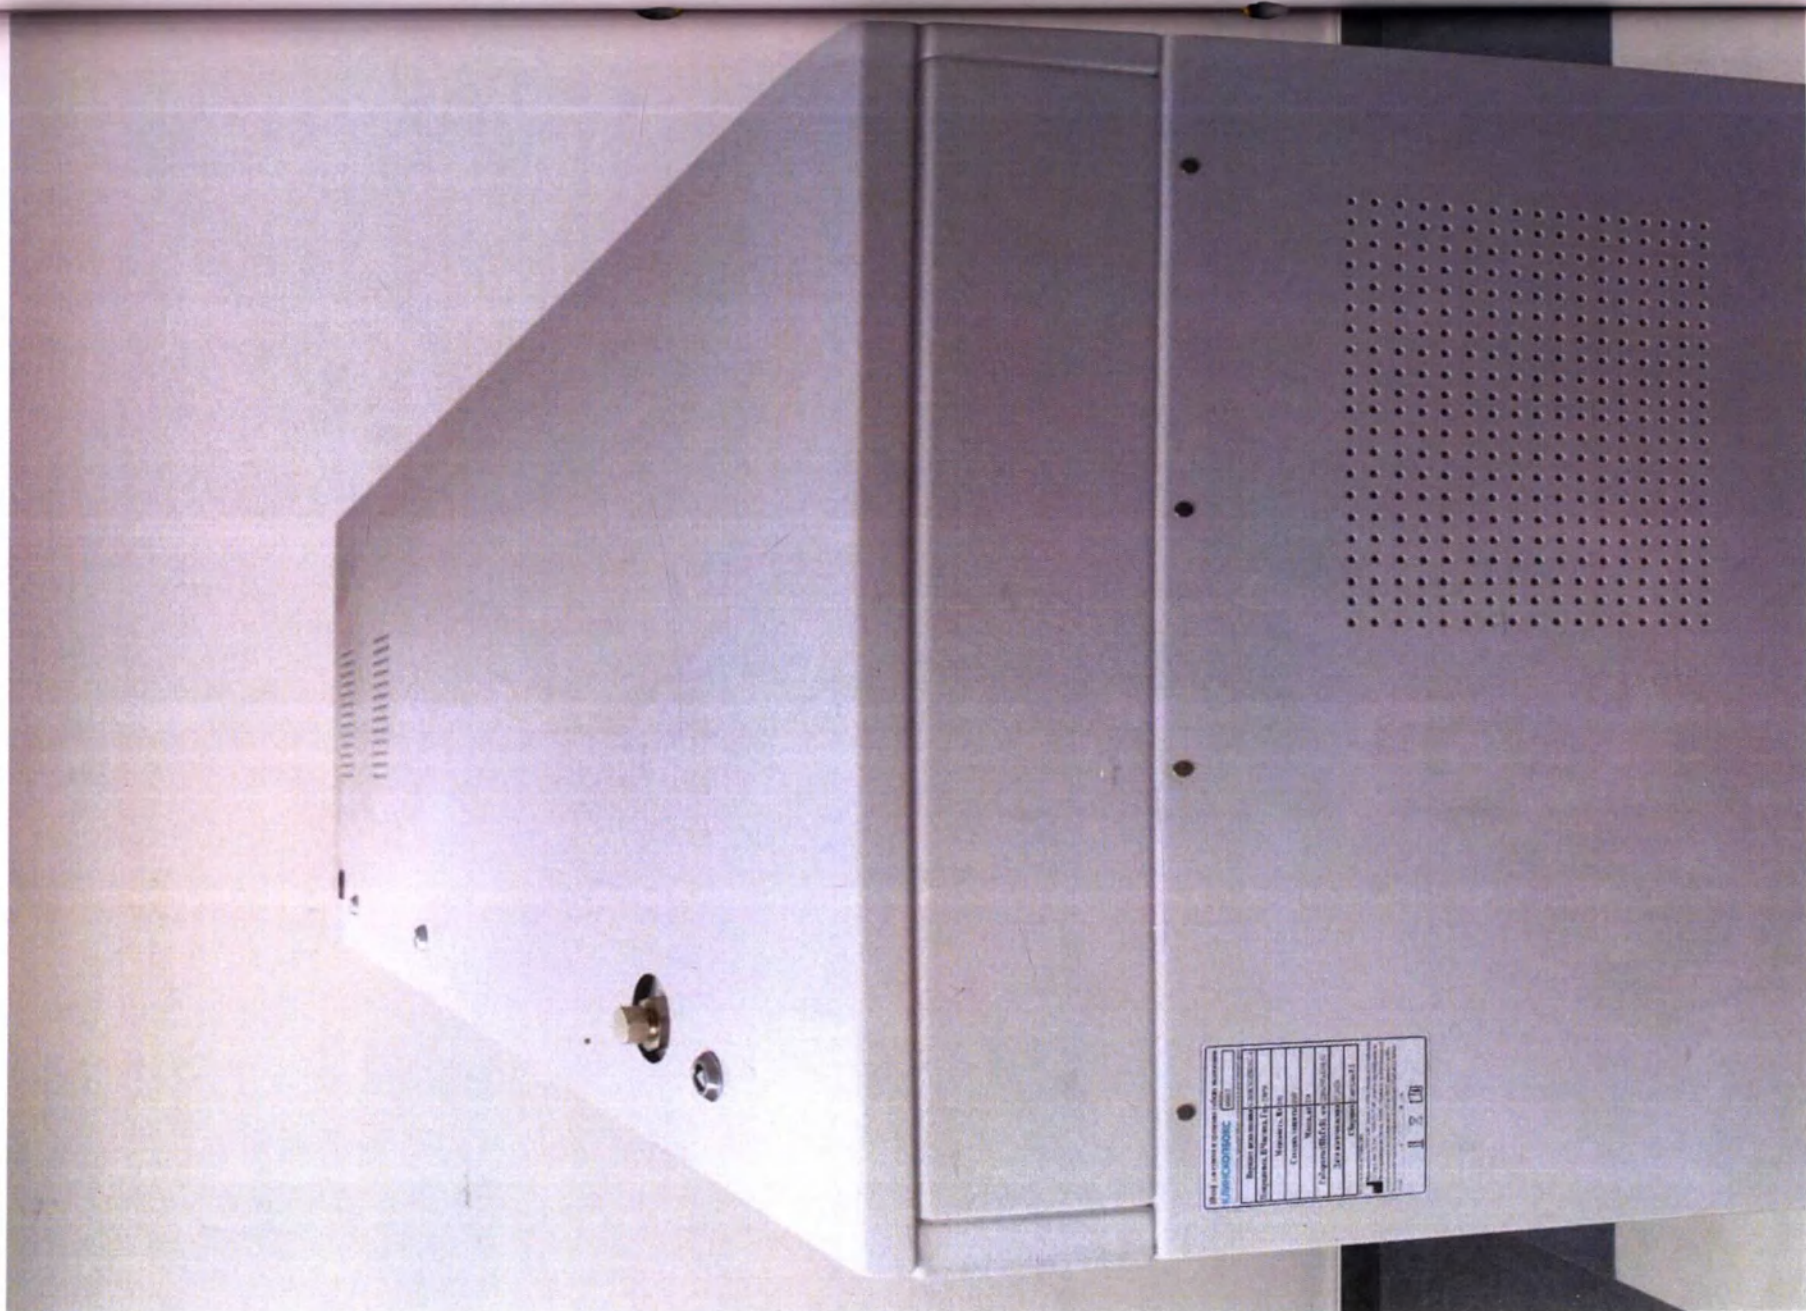


Фотографическое изображение №17. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Верхняя крышка технического отсека.

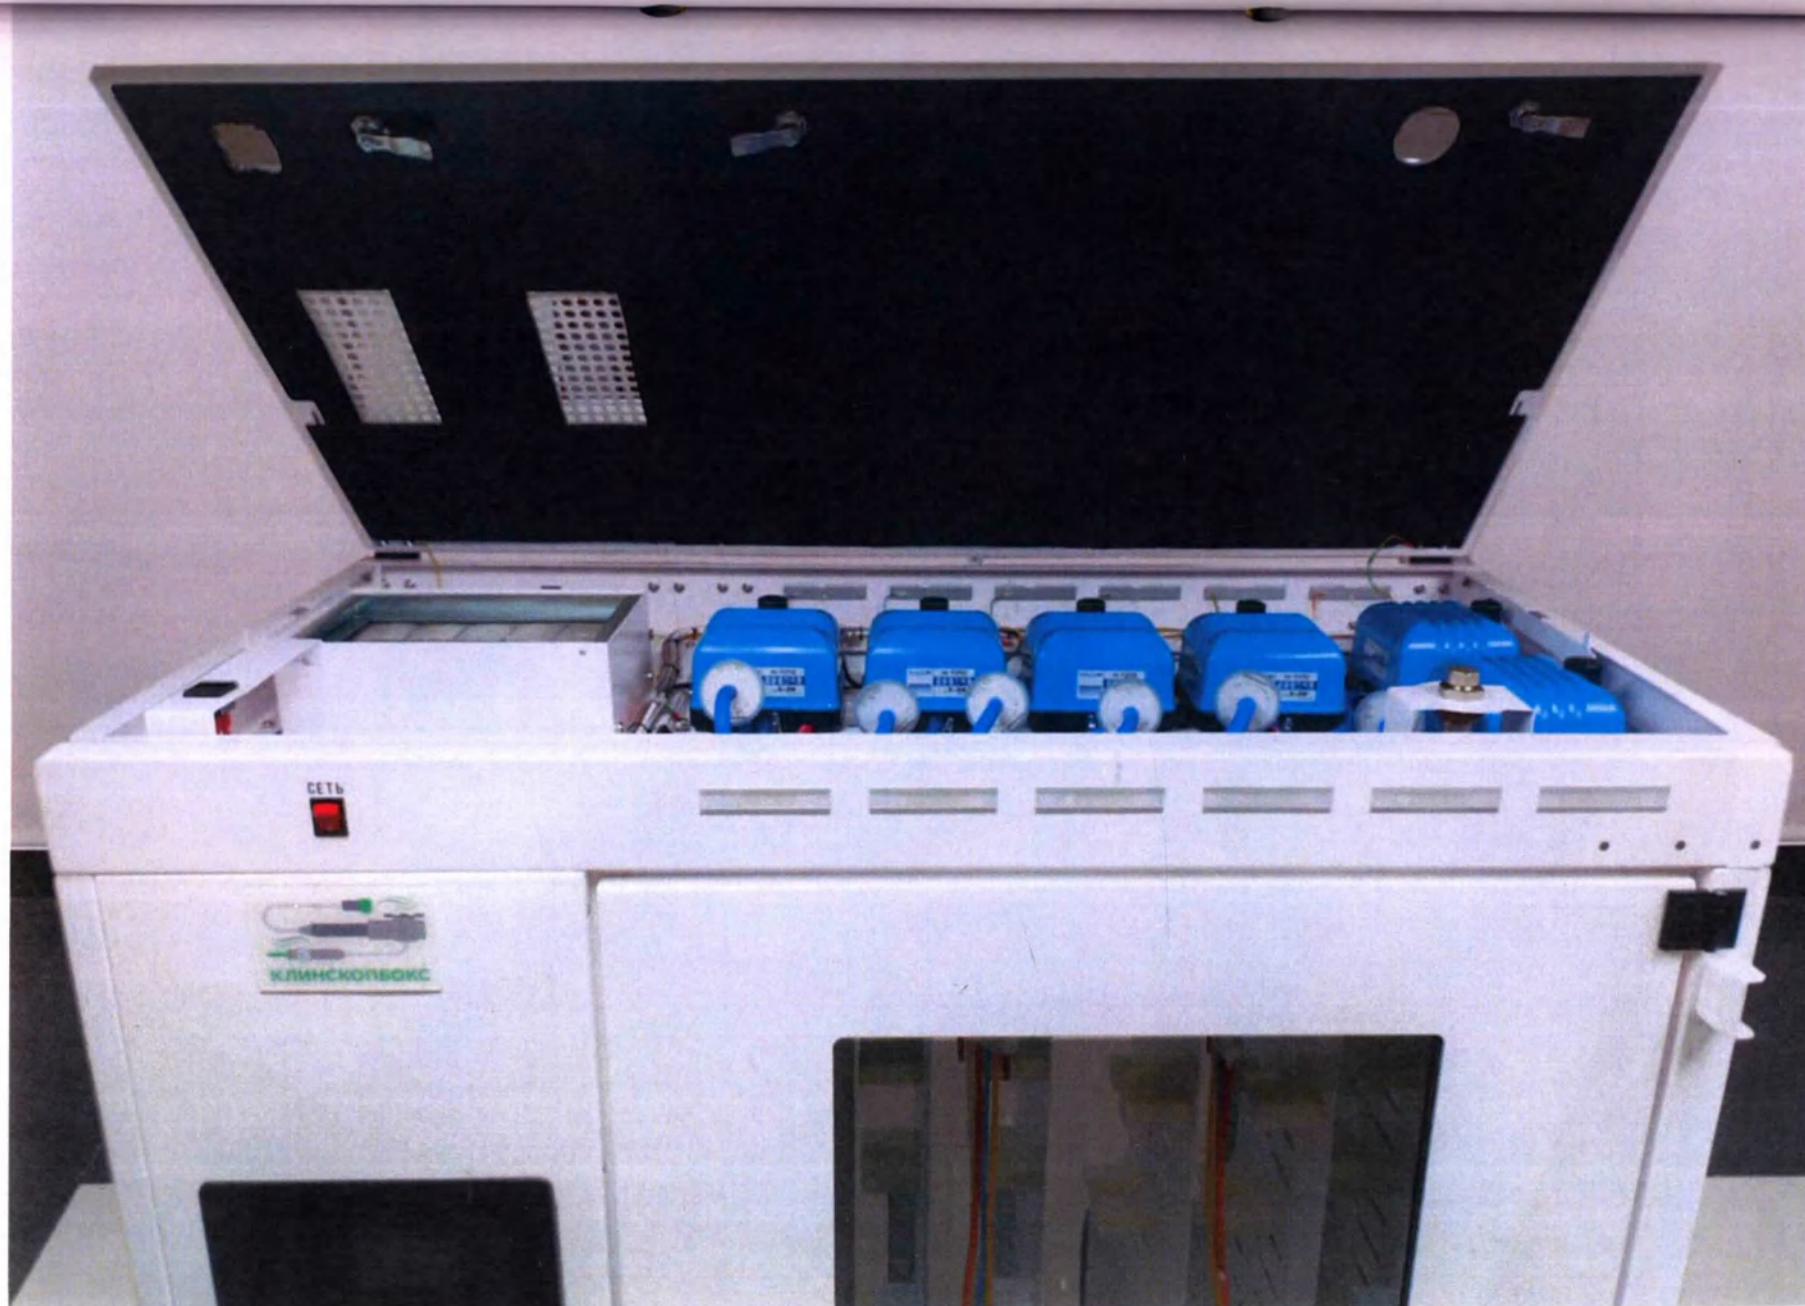


Фотографическое изображение №18. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6. Открыта верхняя крышка технического отсека.

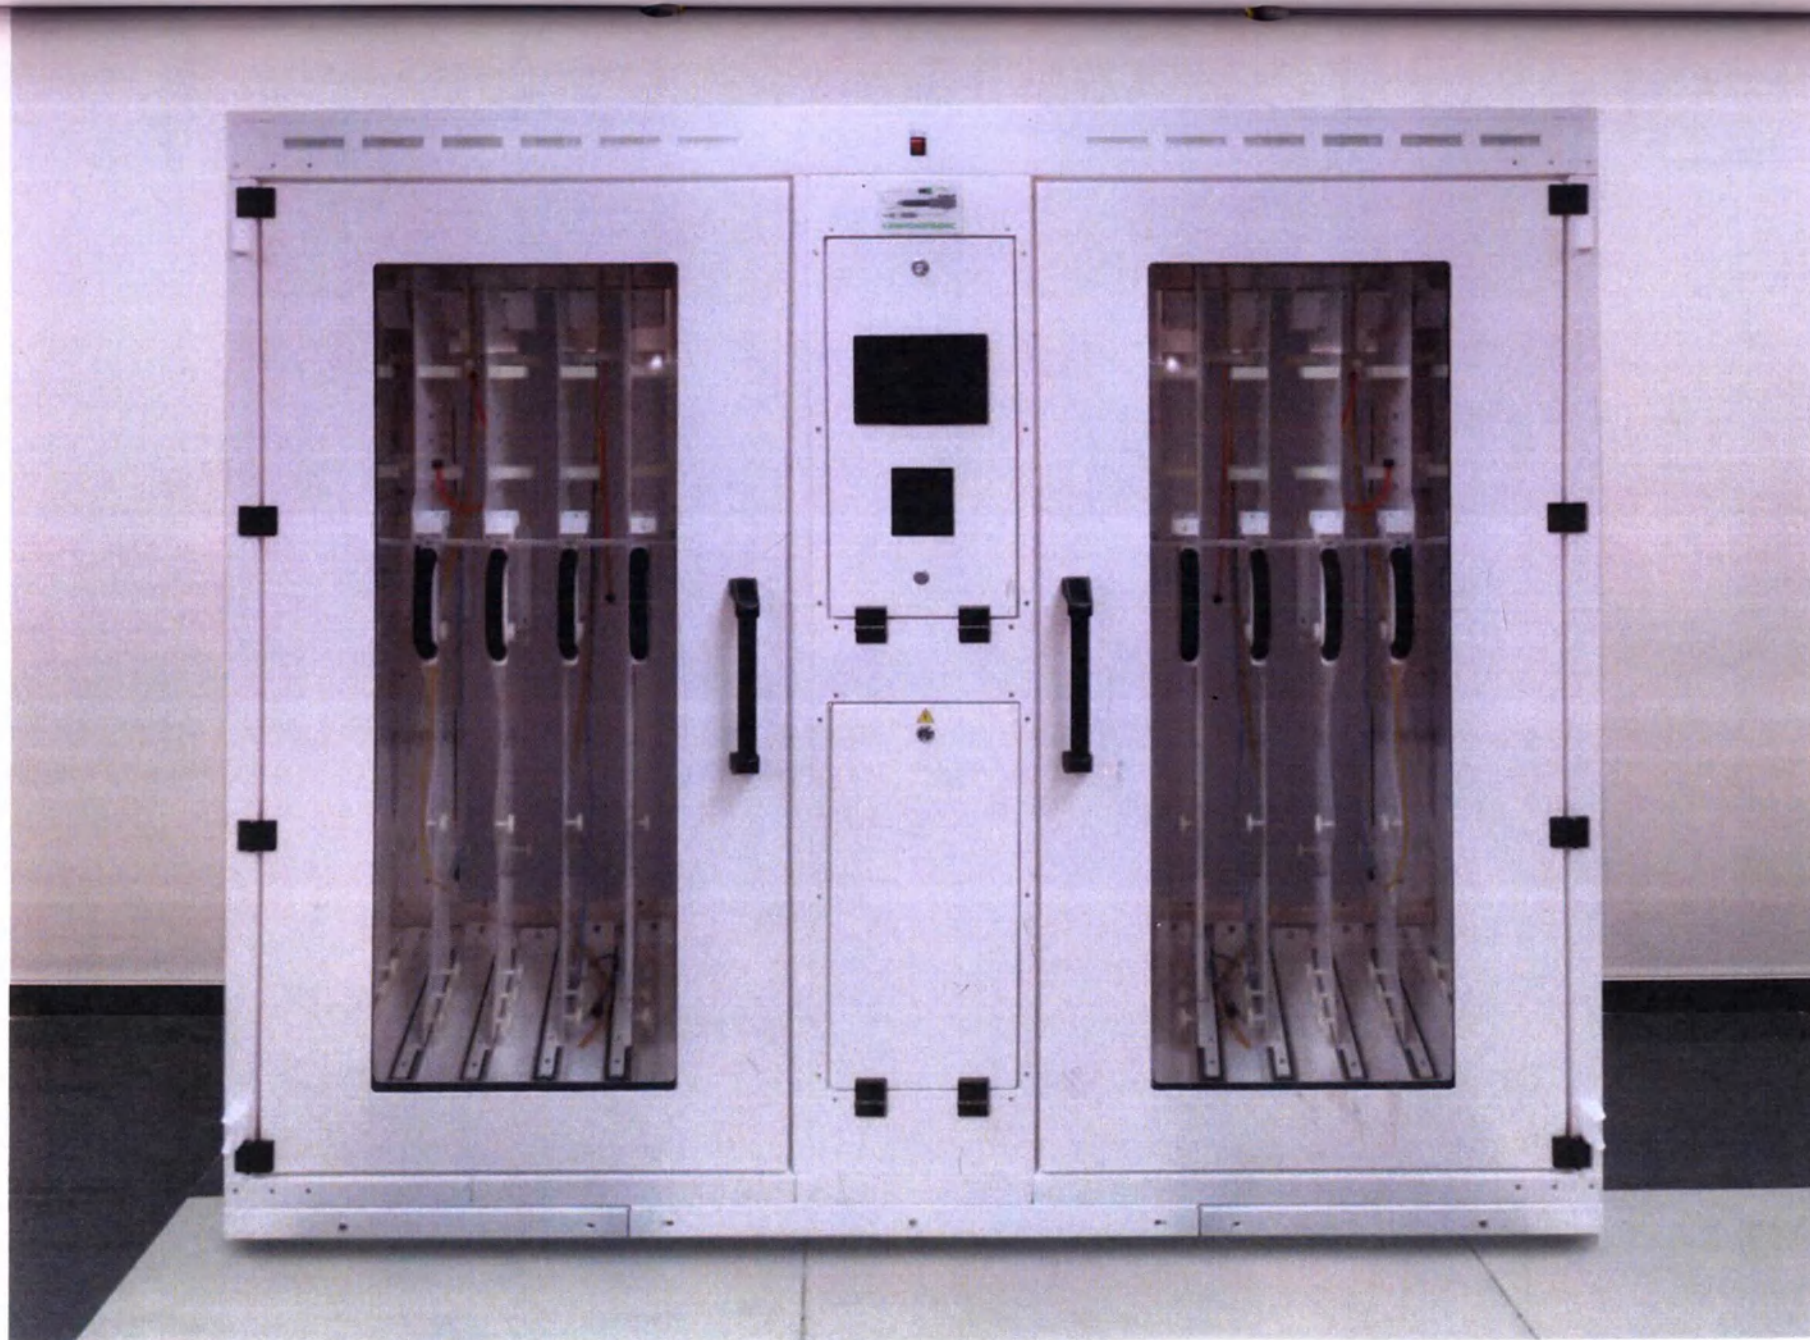


Фотографическое изображение №19. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Вид Шкафа спереди.

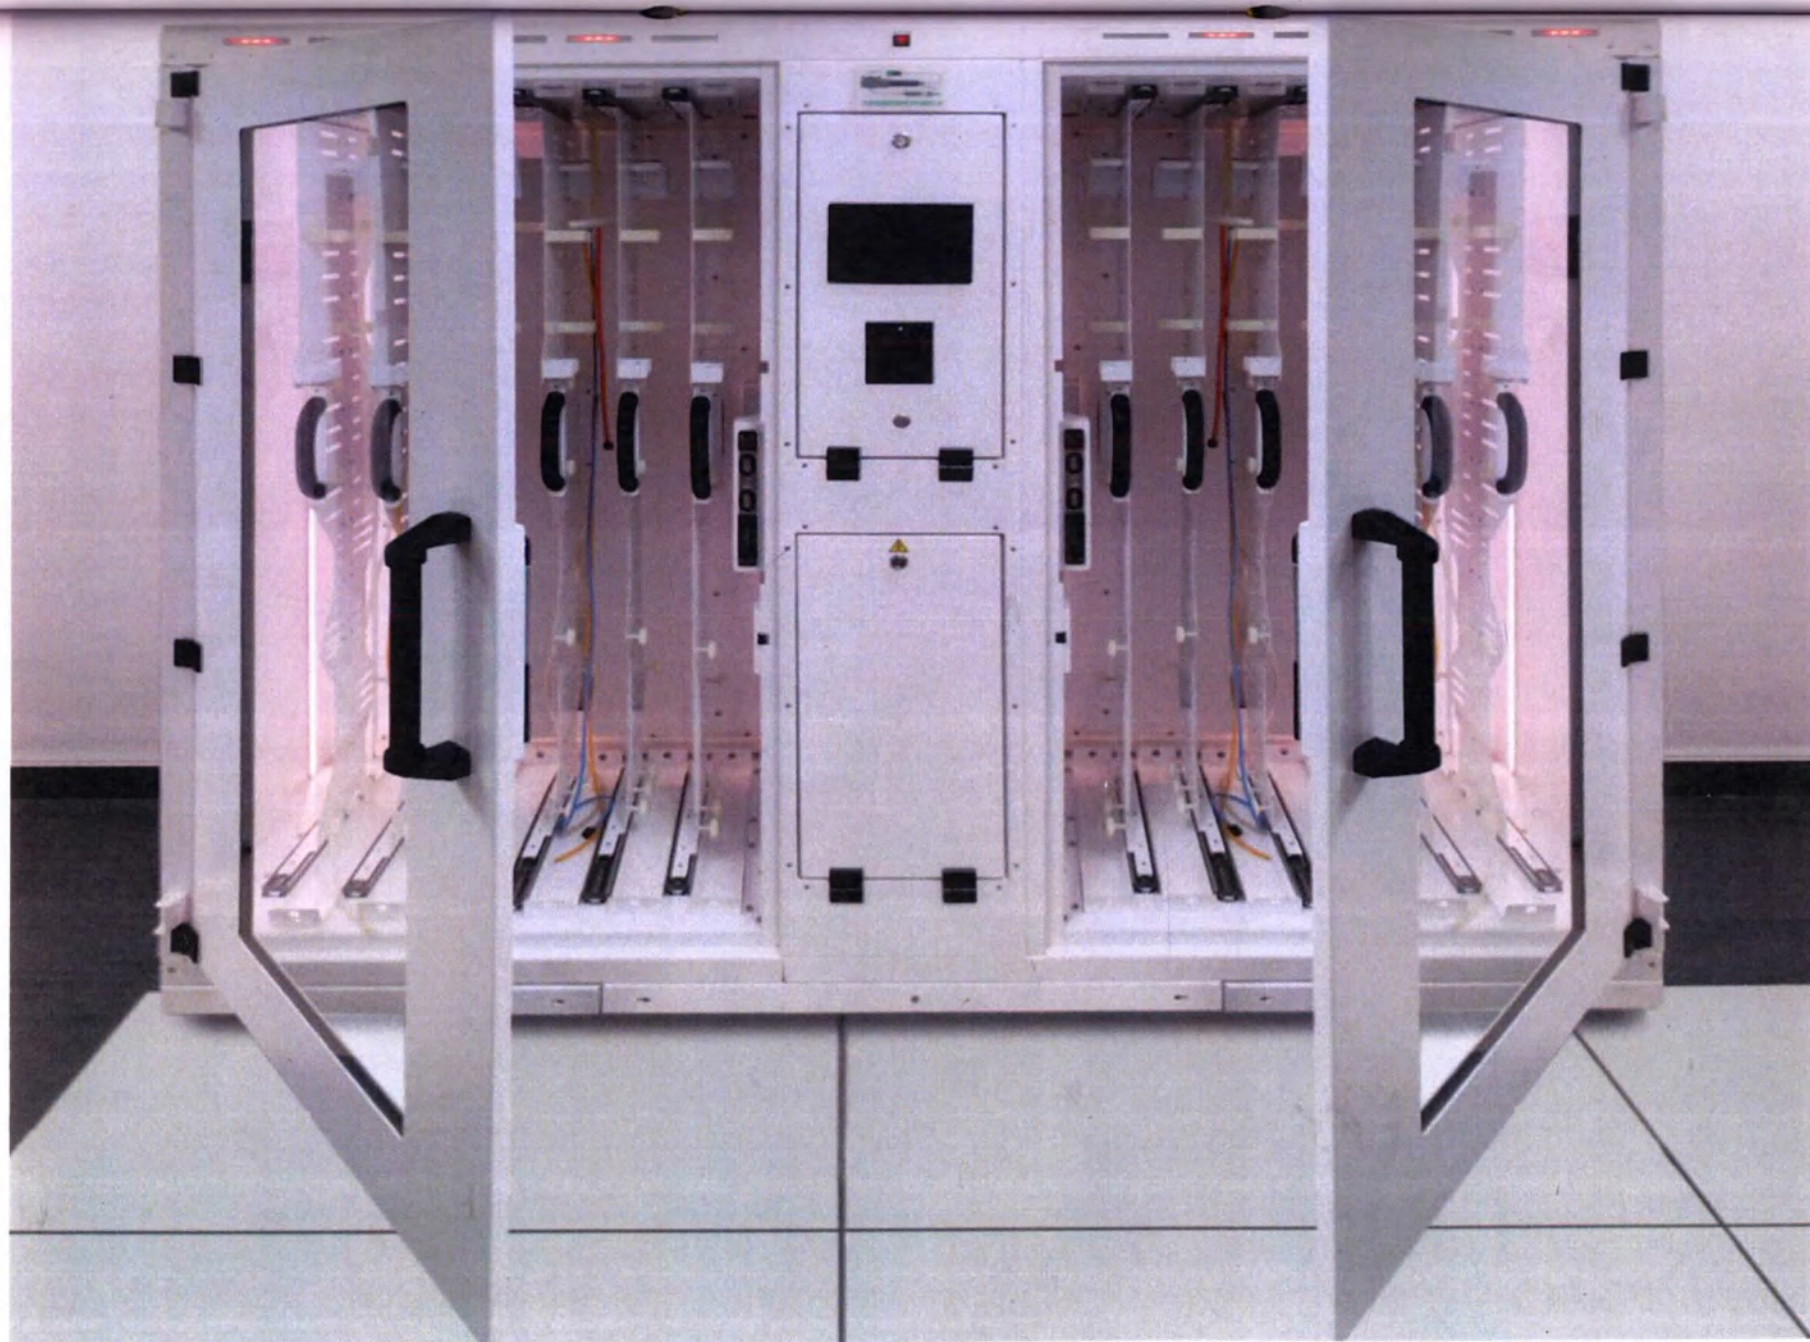


Фотографическое изображение №20. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Открыты двери отсеков хранения.

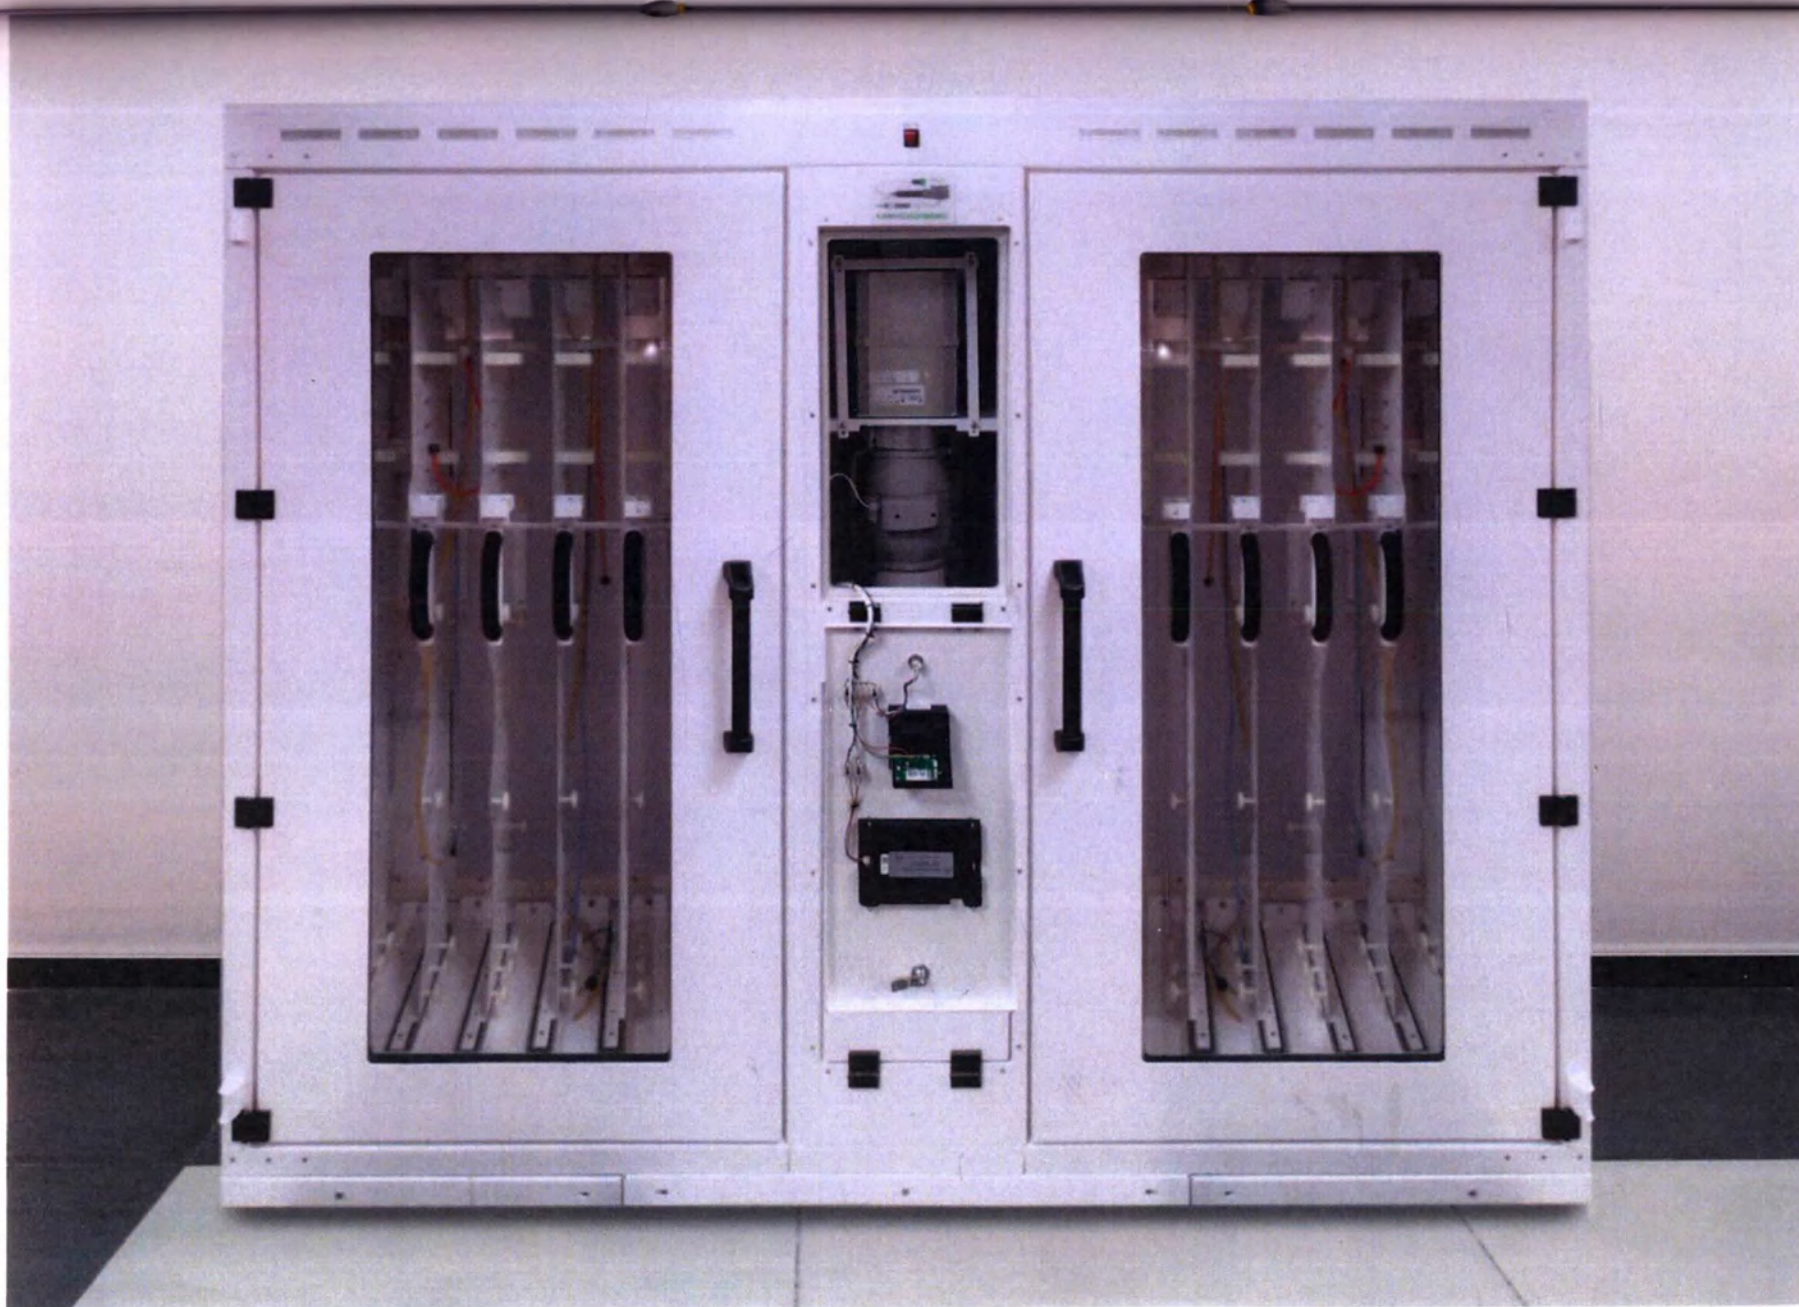

Фотографическое изображение №21. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Открыта дверь технического отсека.

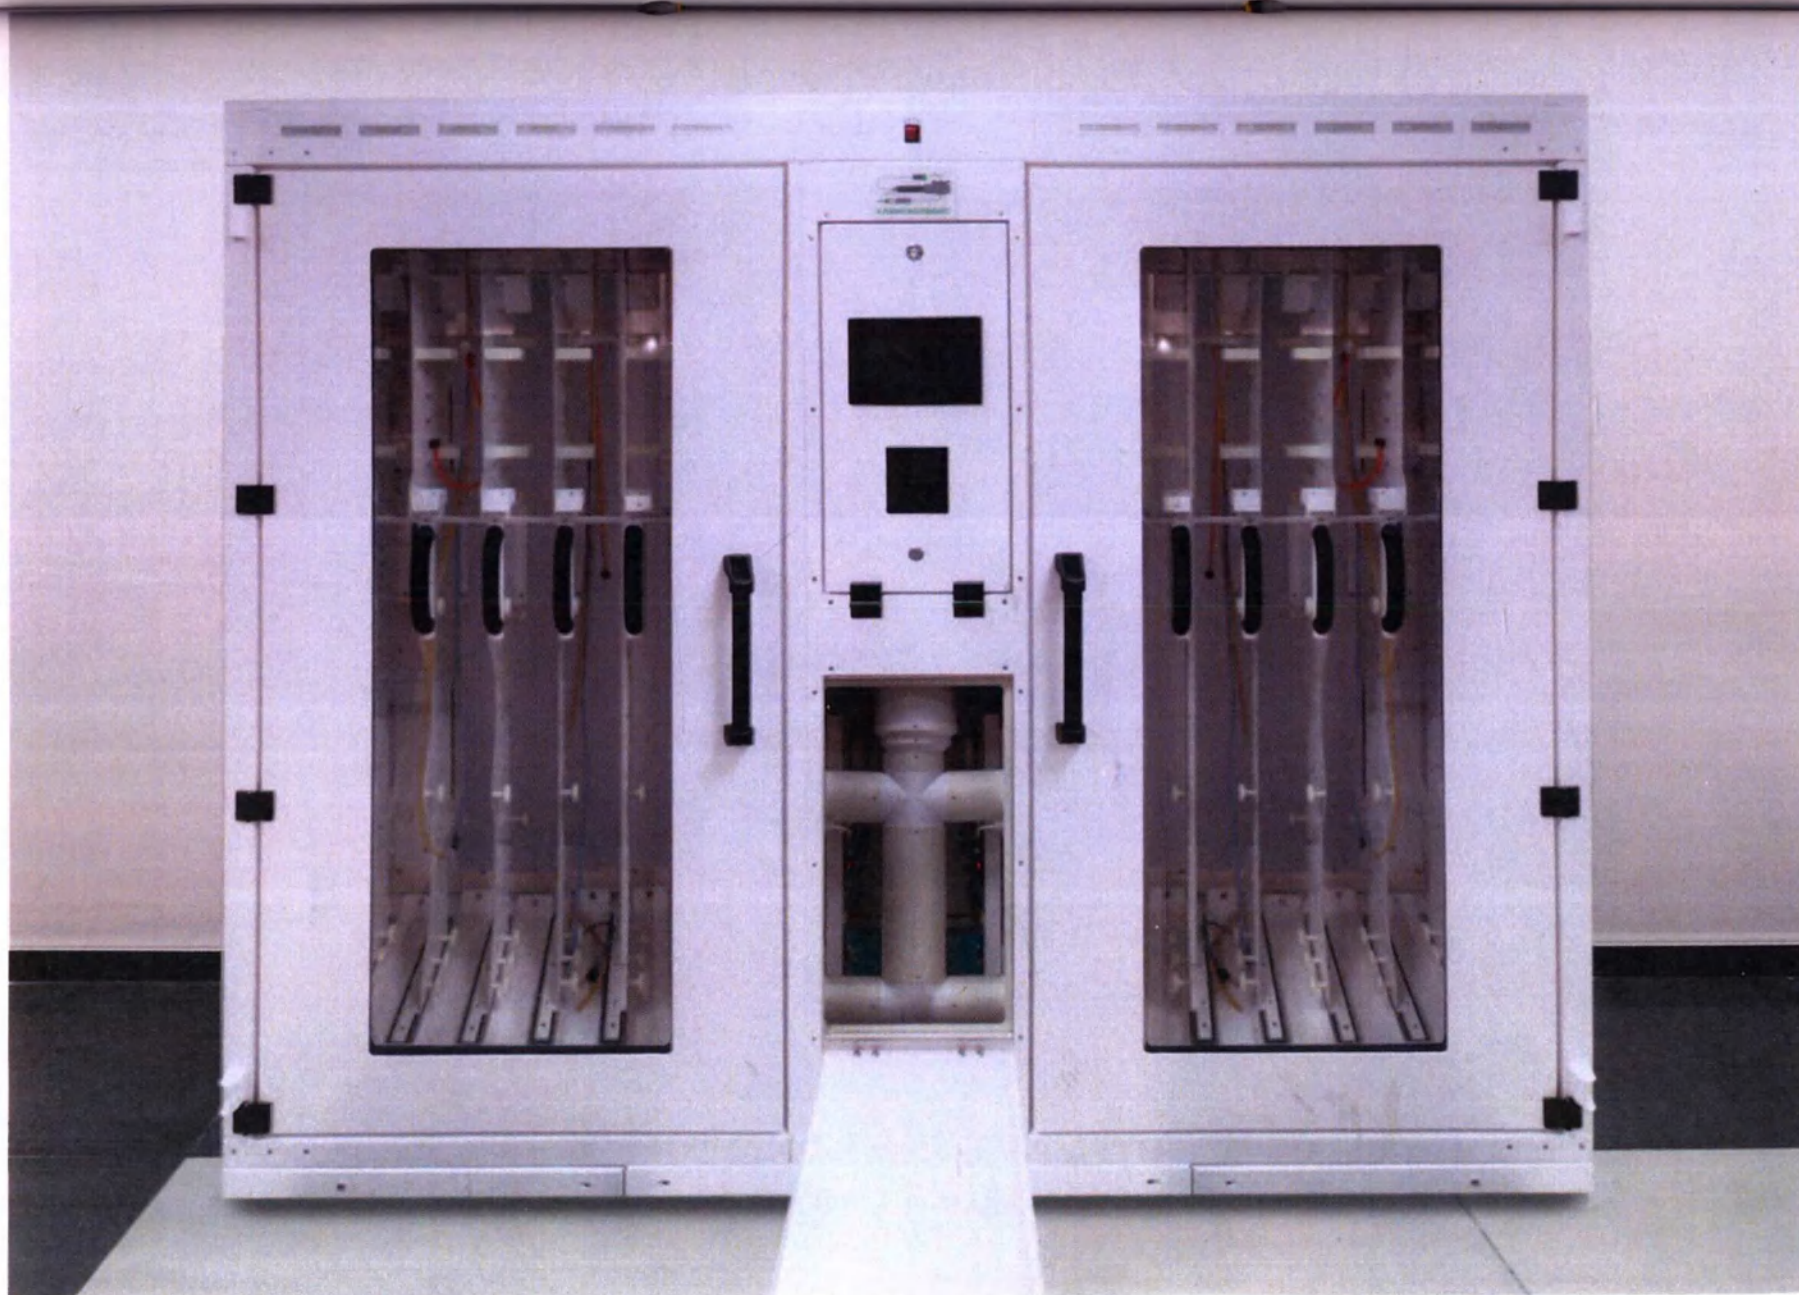

Фотографическое изображение №22. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Открыта дверь технического отсека.

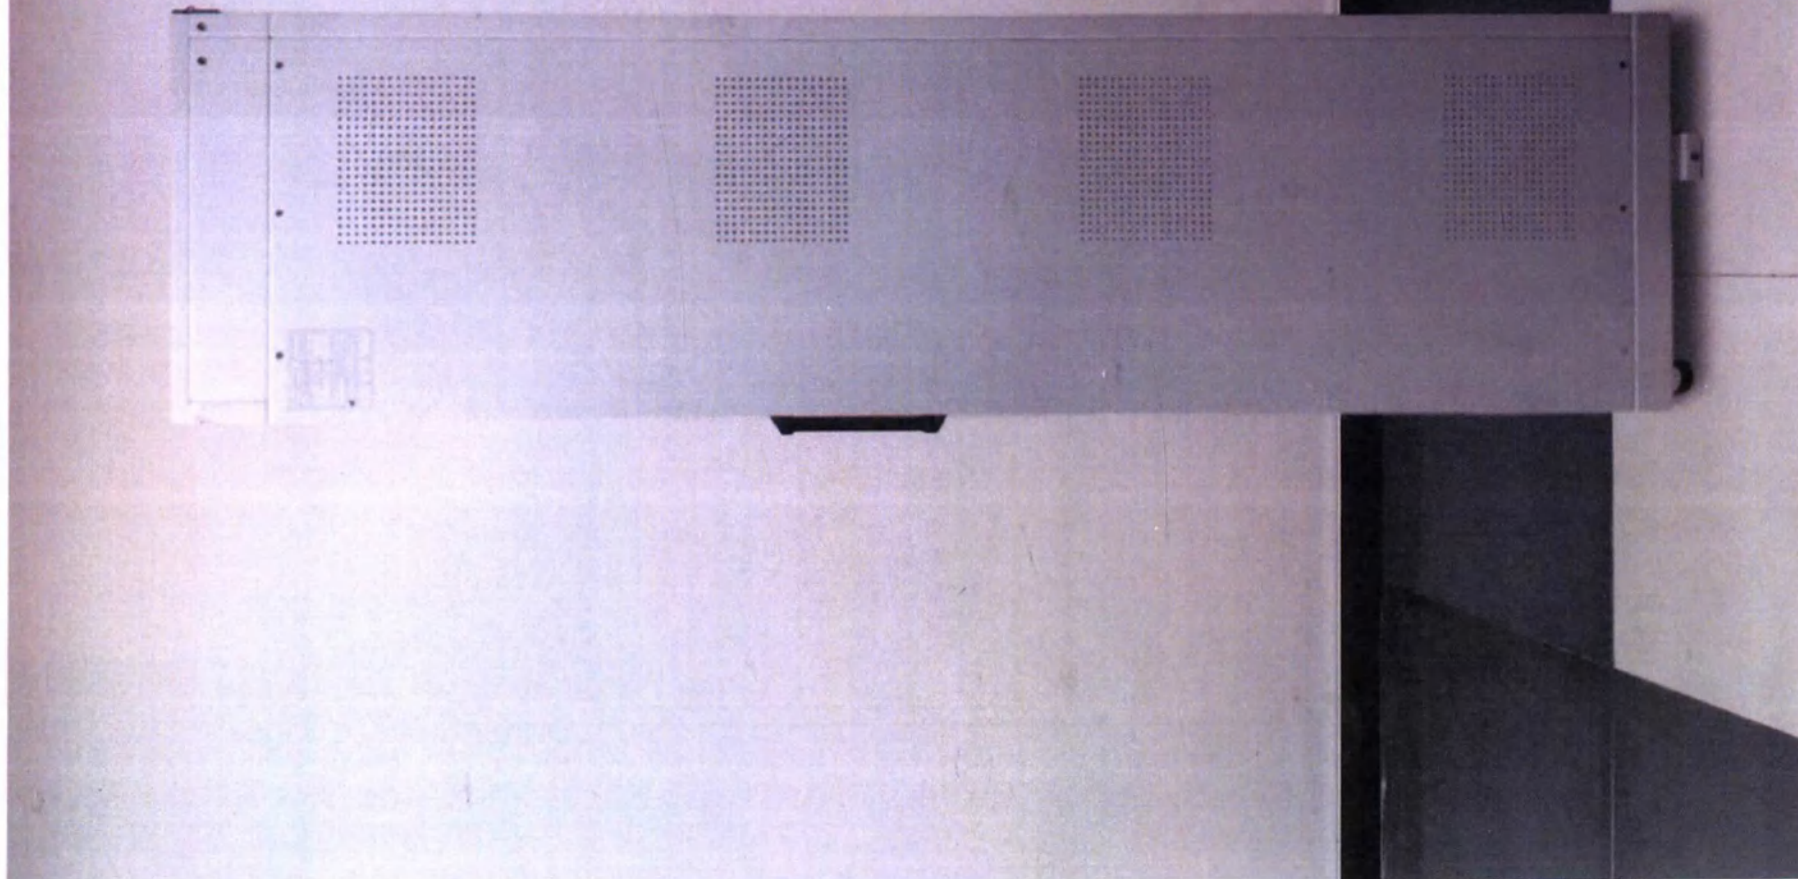

Фотографическое изображение №23. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Вид шкафа с правого бока.

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов

КЛИНСКОПБОКС

деталь № 00003

Рекомендуемое место хранения гибких эндоскопов в ассептической среде


Вариант исполнения	КЛИНСКОПБОКС-12
Напряжение, В/Частота, Гц	~ 230/50
Мощность, Вт	385
Степень защиты	IP10
Масса, кг	330
Габариты (ШхГхВ), мм	2250х591х1958,50
Дата изготовления	07.2023г.
Сборщик	Санталин Р.З.

ТУ 32.50.50-001-42718084-2023


Производитель: ООО "ЦДБ", Россия, 111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная д. 2, стр. 6, пом. 20. Тел.: +7(991)591-77-97, эл. почта: cdg.msk@yandex.ru

Место производства: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Металлистов д. 8
Условия эксплуатации при температуре от +10 до +40 °С, влажность до 80%.
Использование владение утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


ру № от " " 20 год



Фотографическое изображение №24. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Маркировка Шкафа.

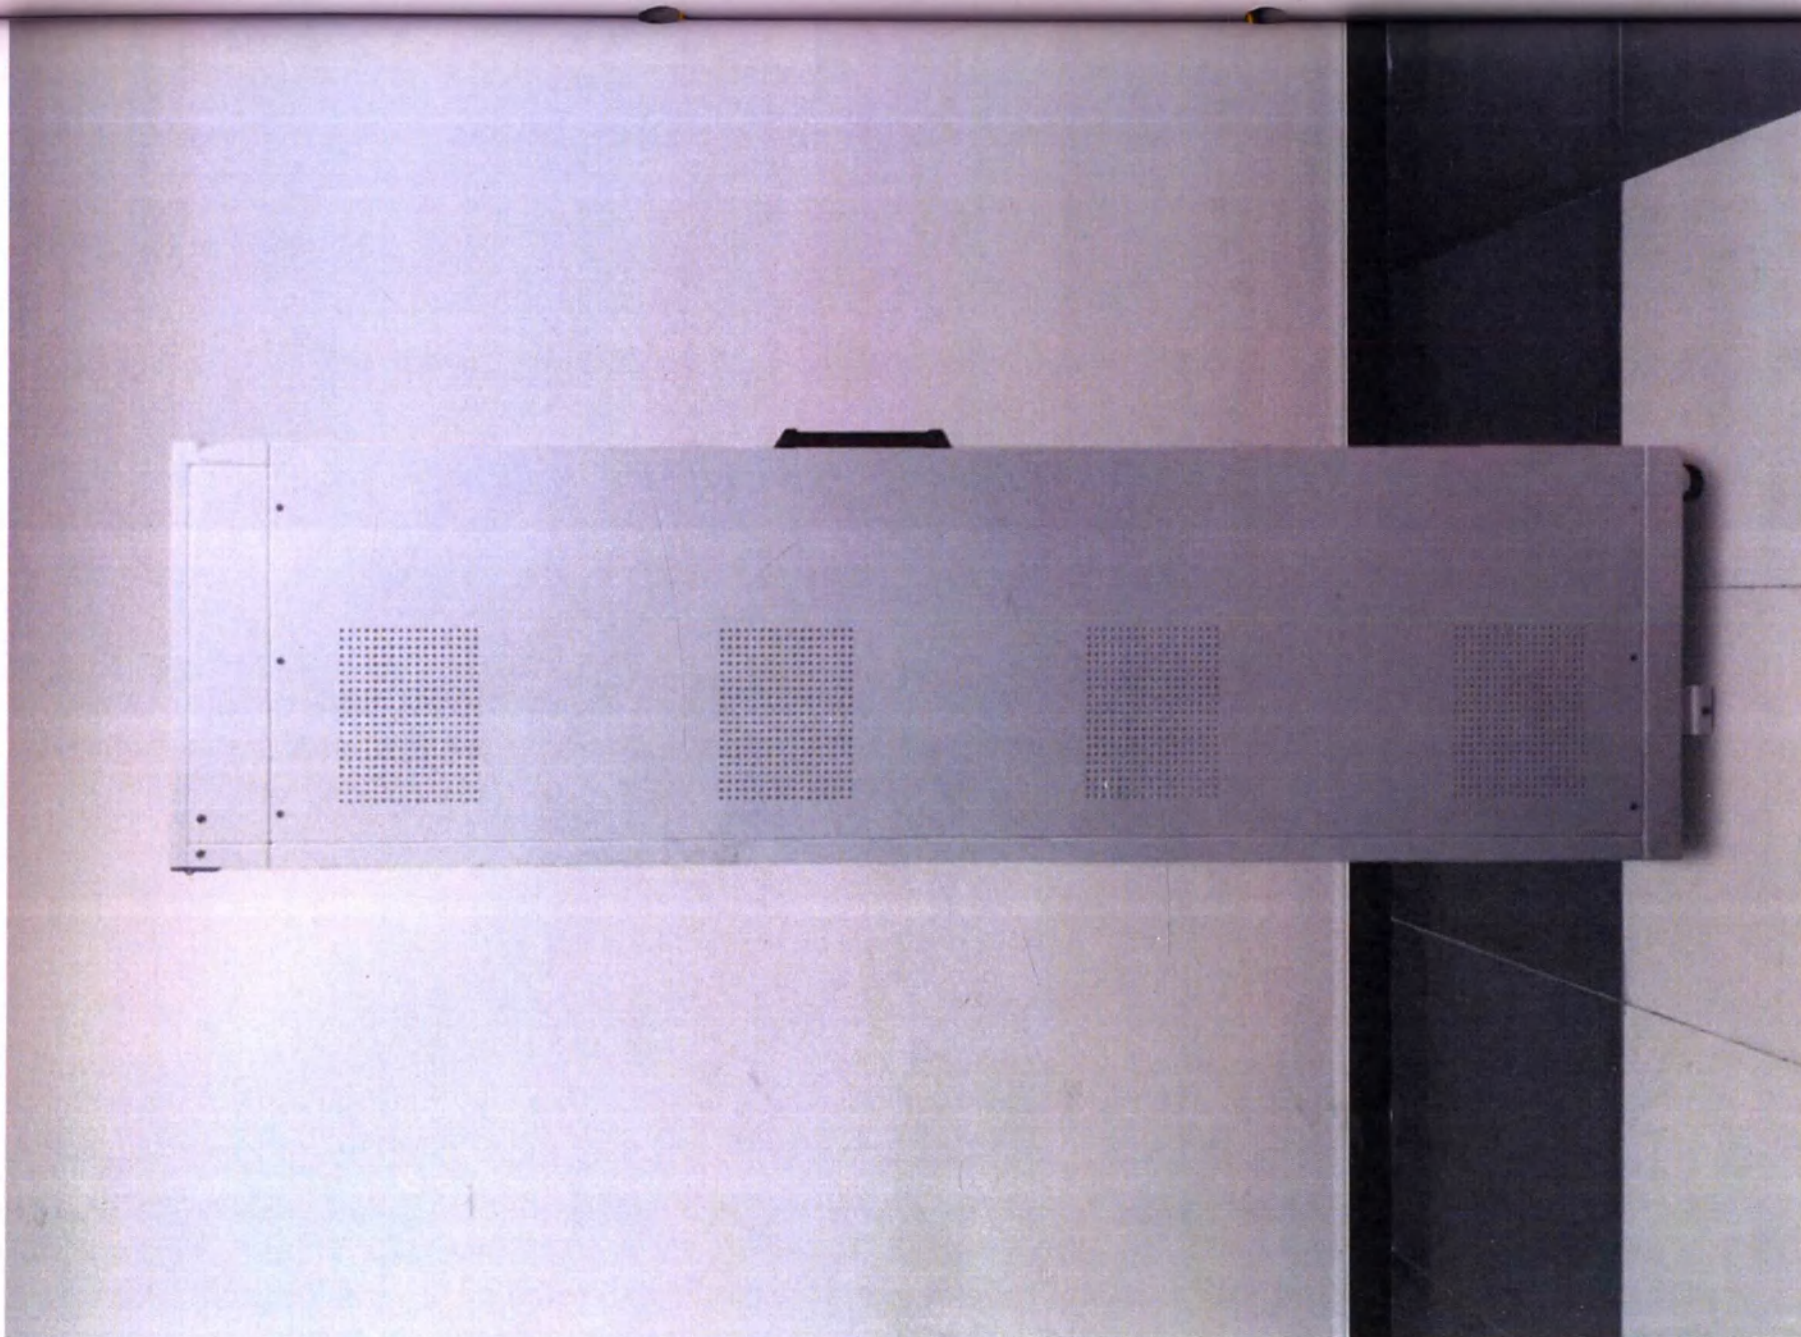


Фотографическое изображение №25. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Вид Шкафа с левого бока.

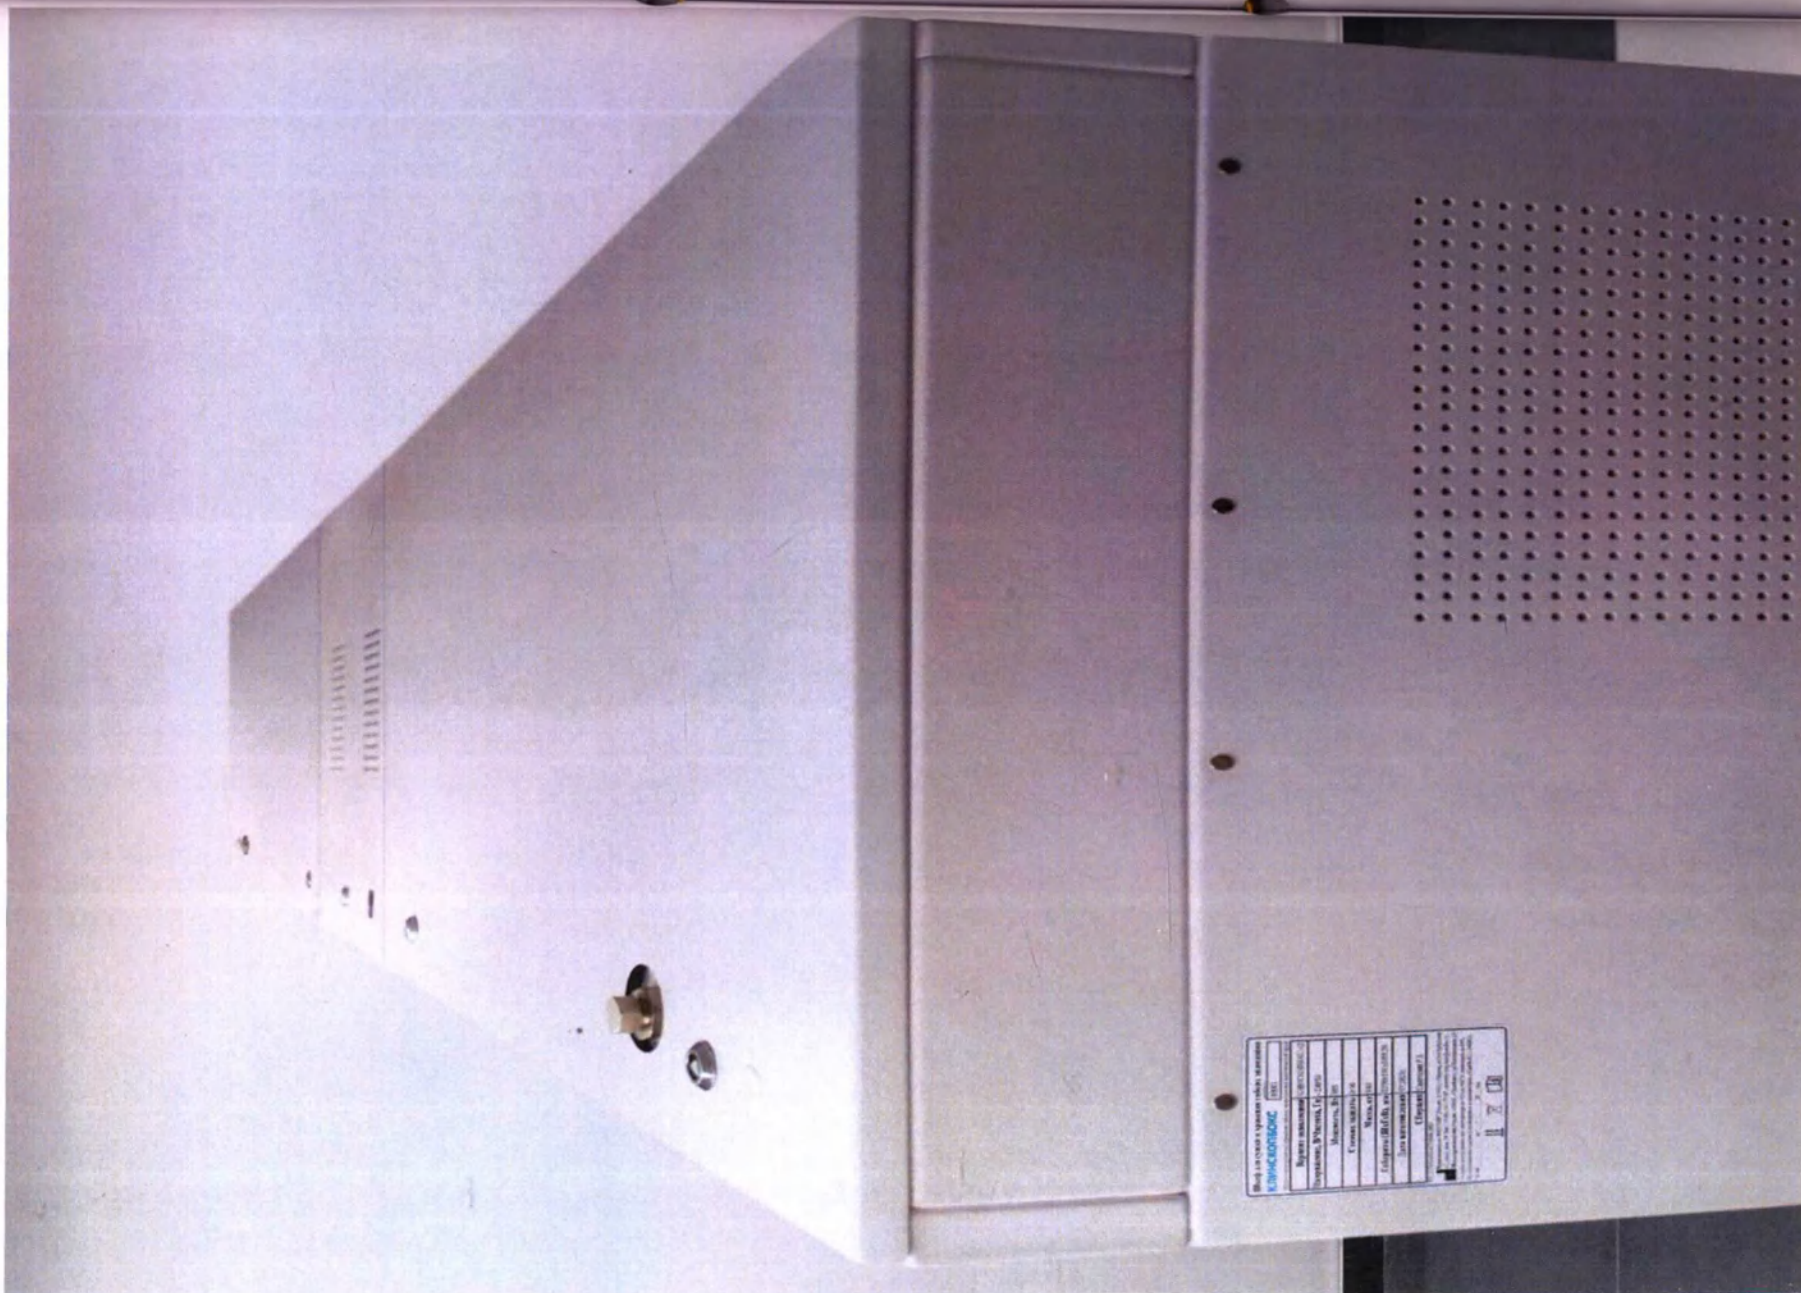


Фотографическое изображение №26. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Верхняя крышка технического отсека.




Фотографическое изображение №27. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12. Открыта верхняя крышка технического отсека.

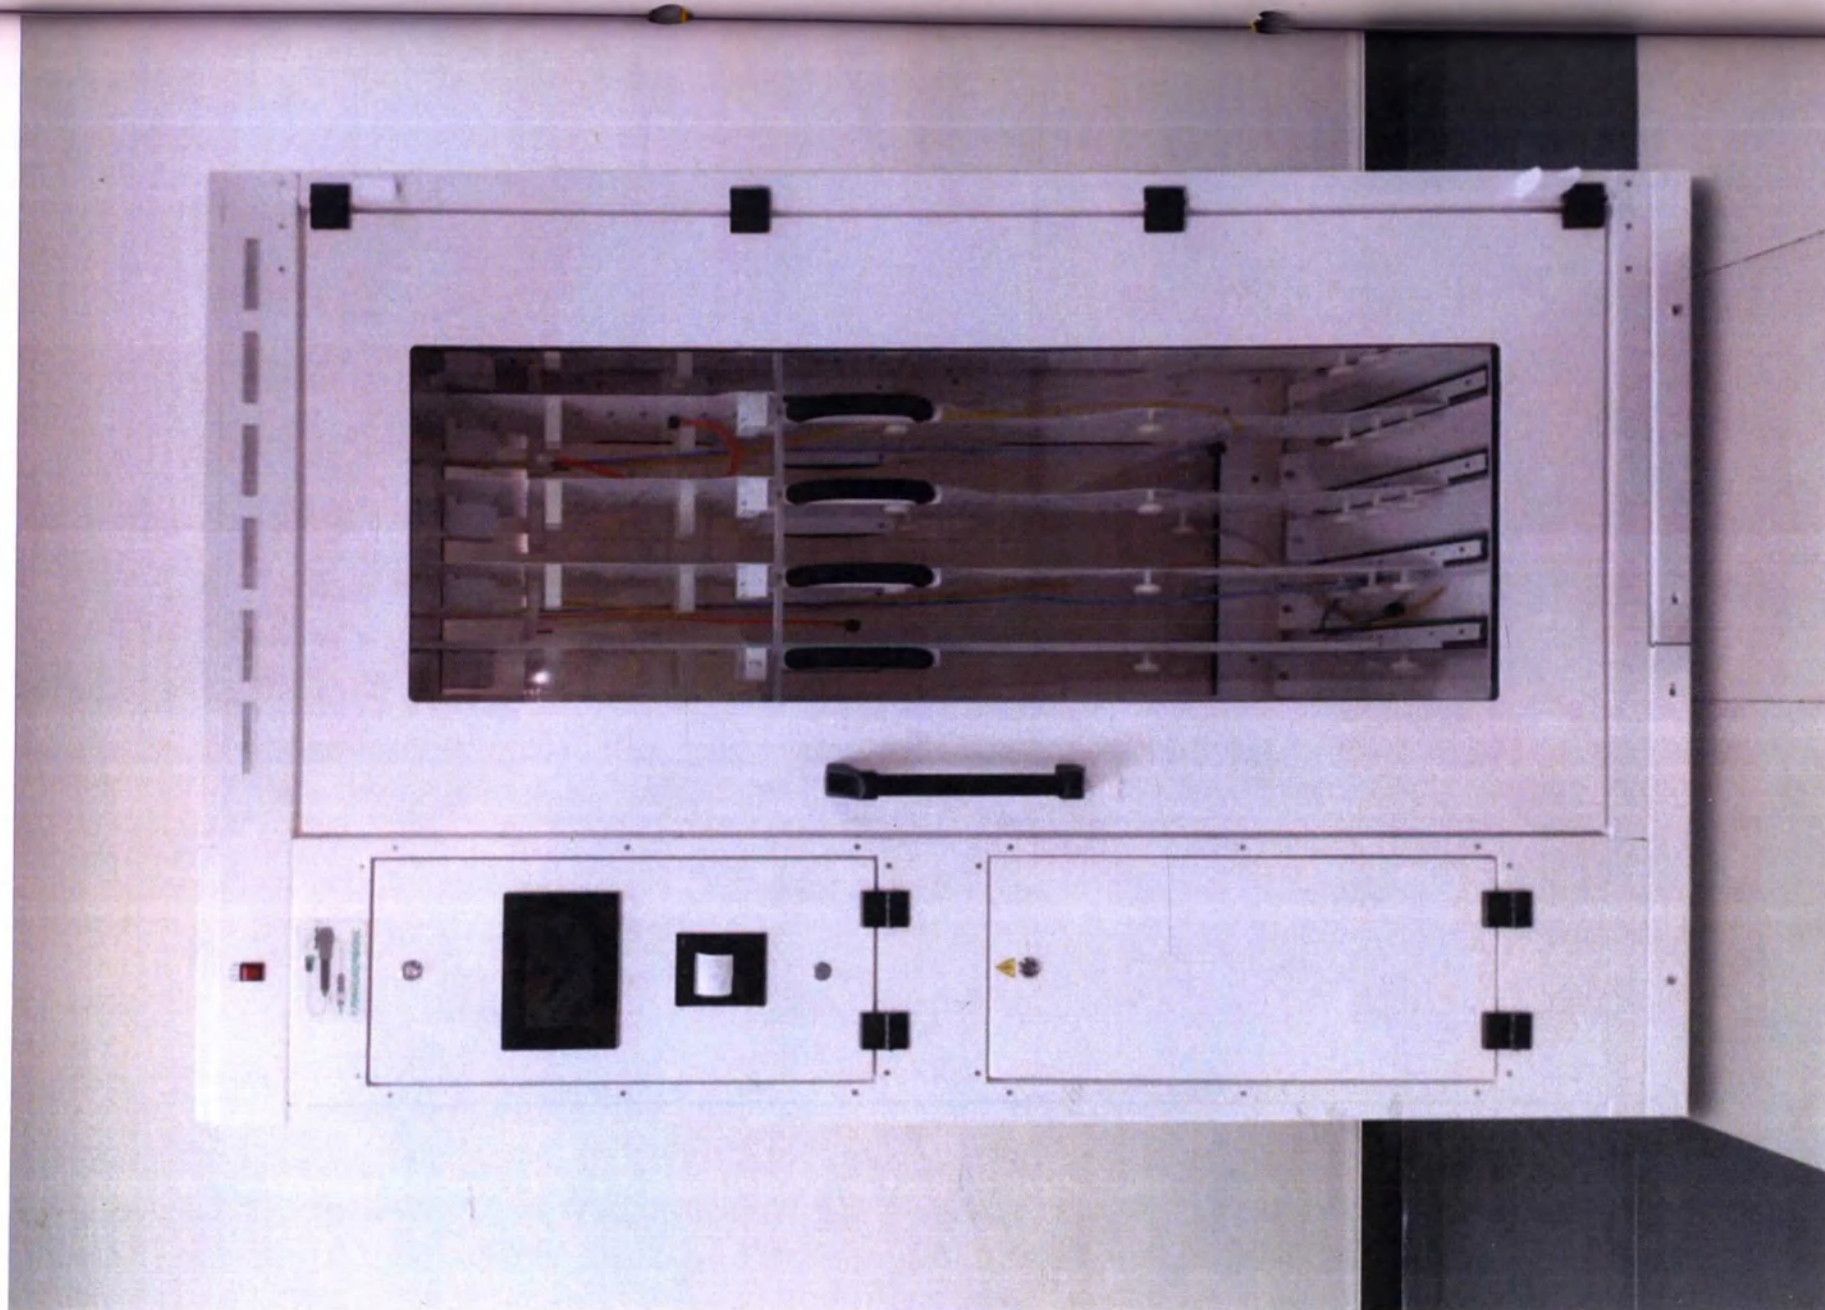


Фотографическое изображение №28. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Вид Шкафа спереди с одной стороны.

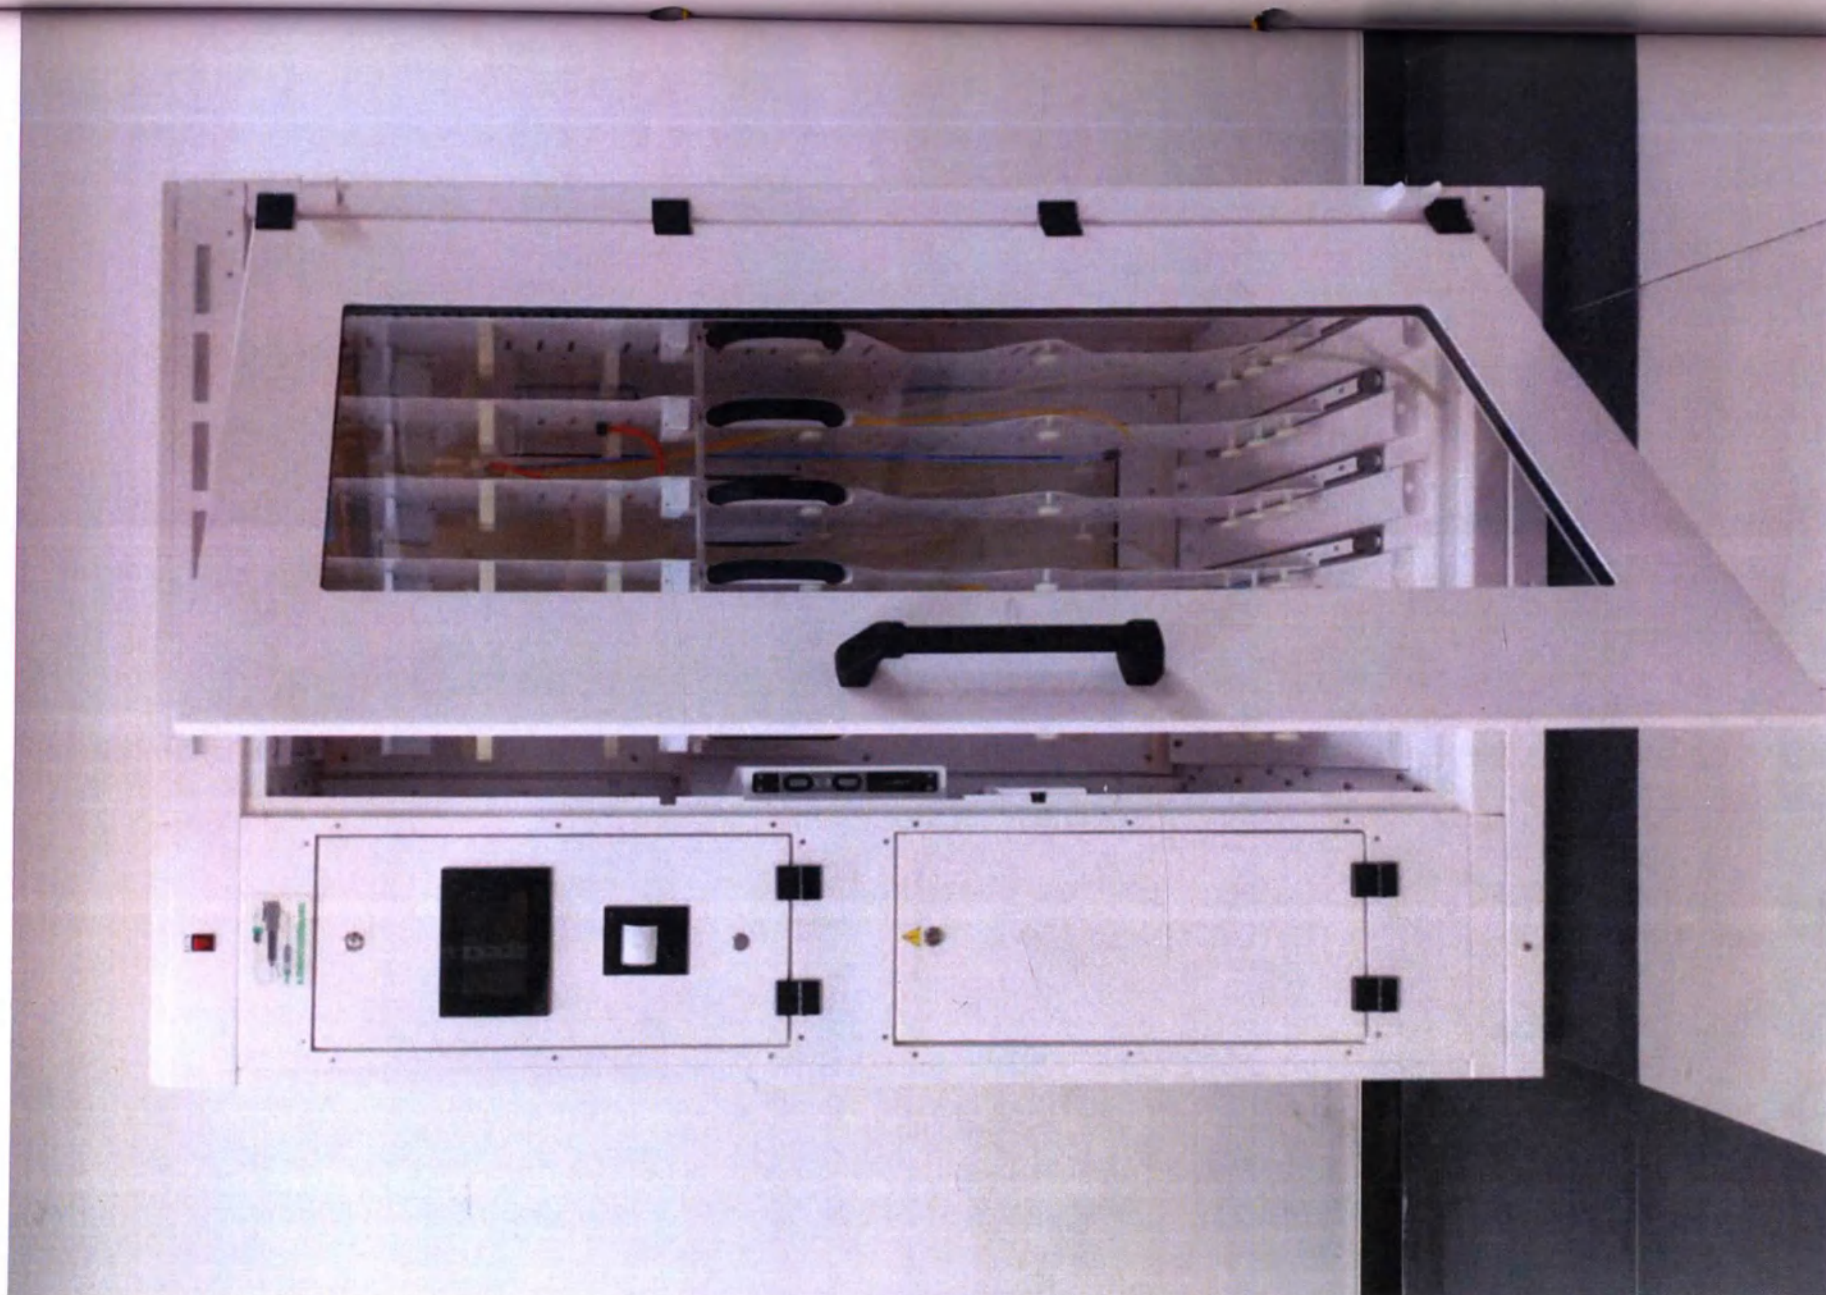


Фотографическое изображение №29. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-БПРО. Открыта дверь отсека хранения с одной стороны.

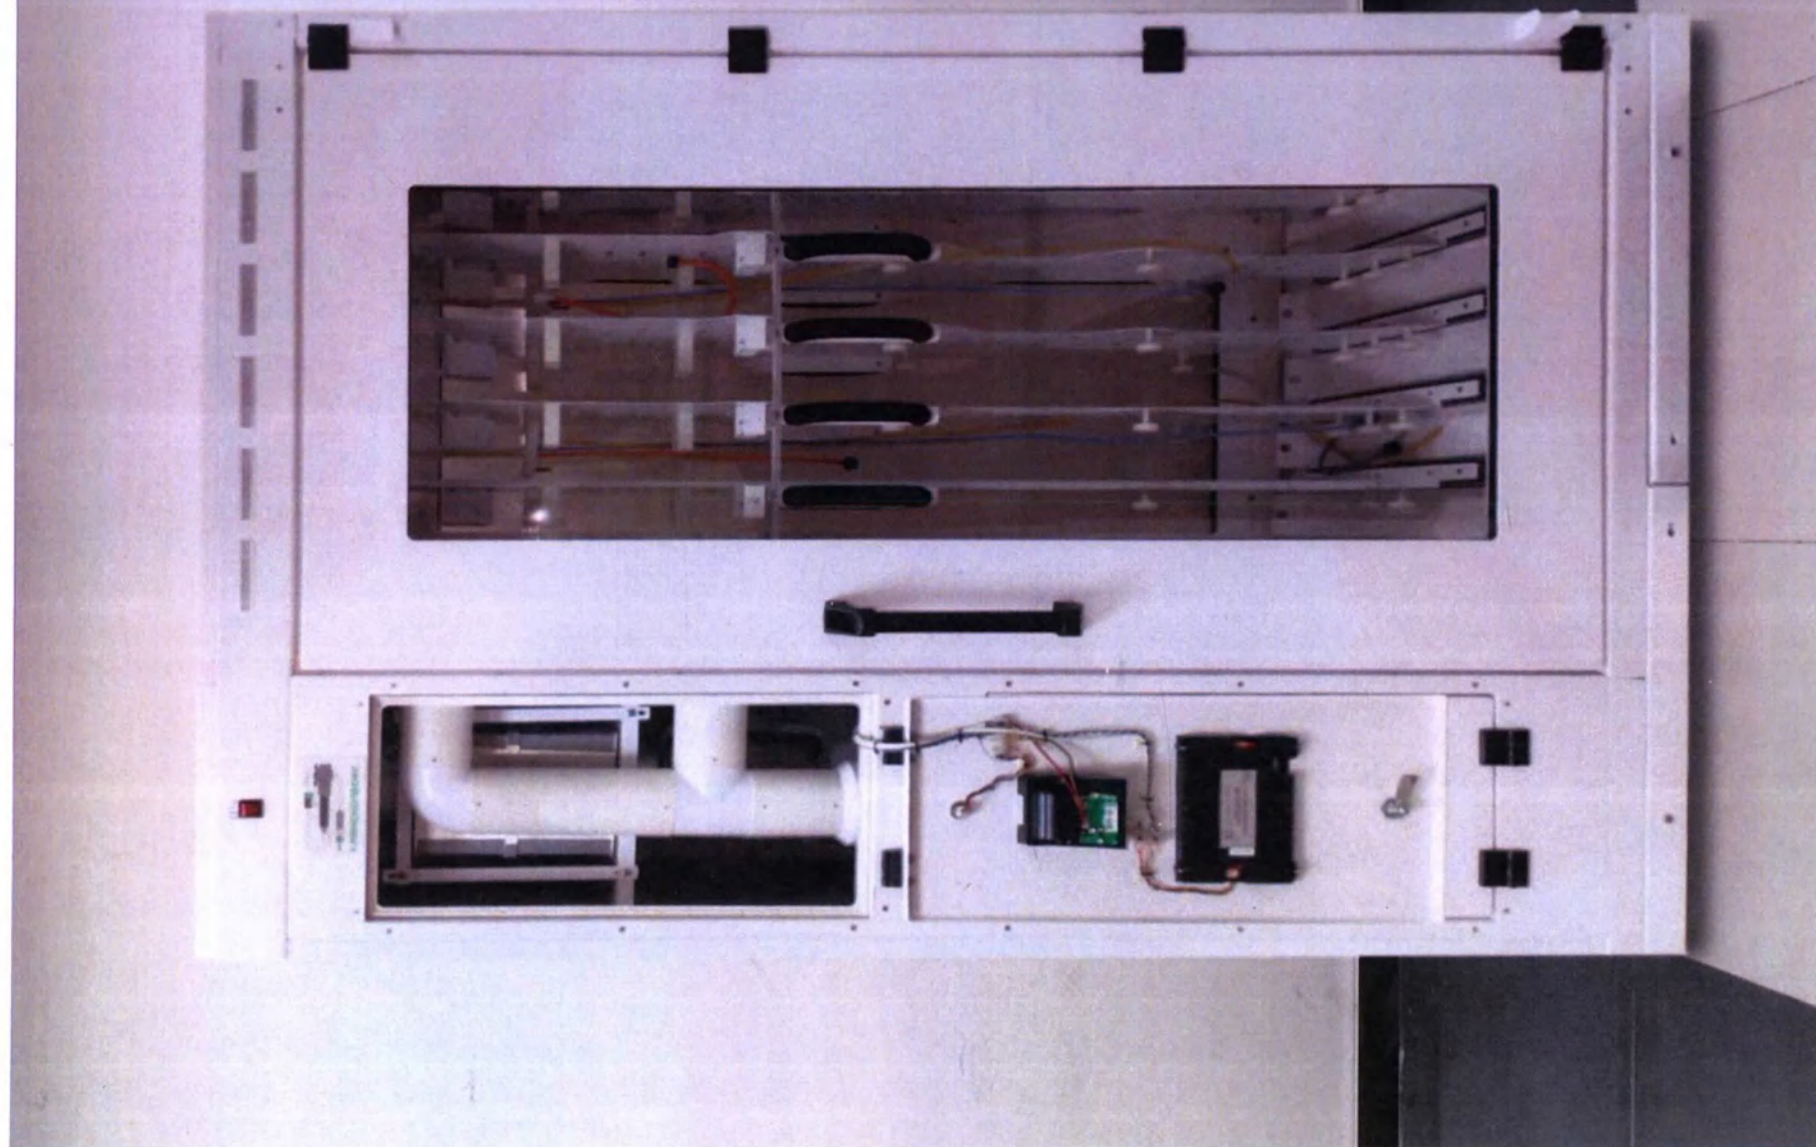


Фотографическое изображение №30. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Открыта дверь технического отсека с одной стороны.

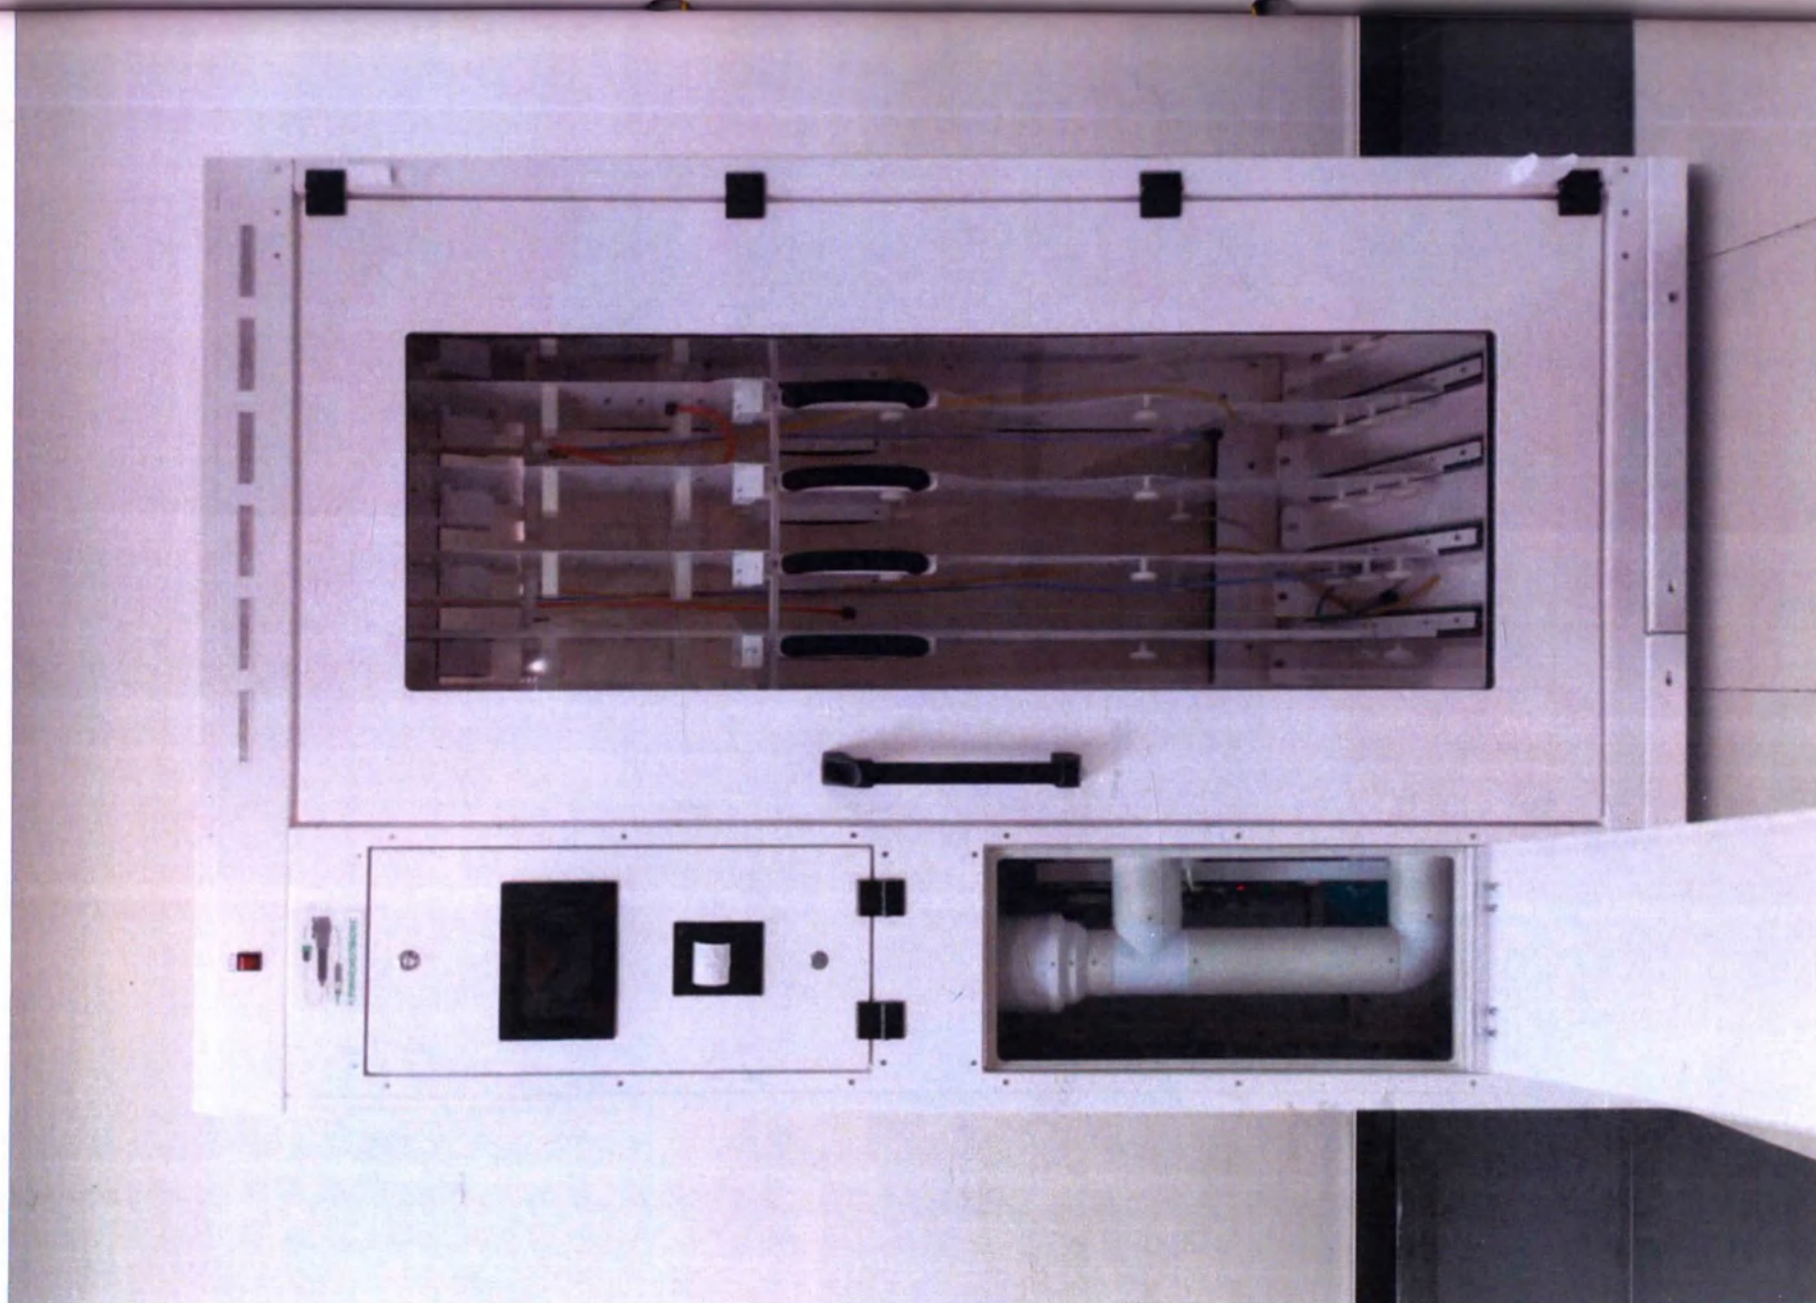


Фотографическое изображение №31. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Открыта дверь технического отсека с одной стороны.

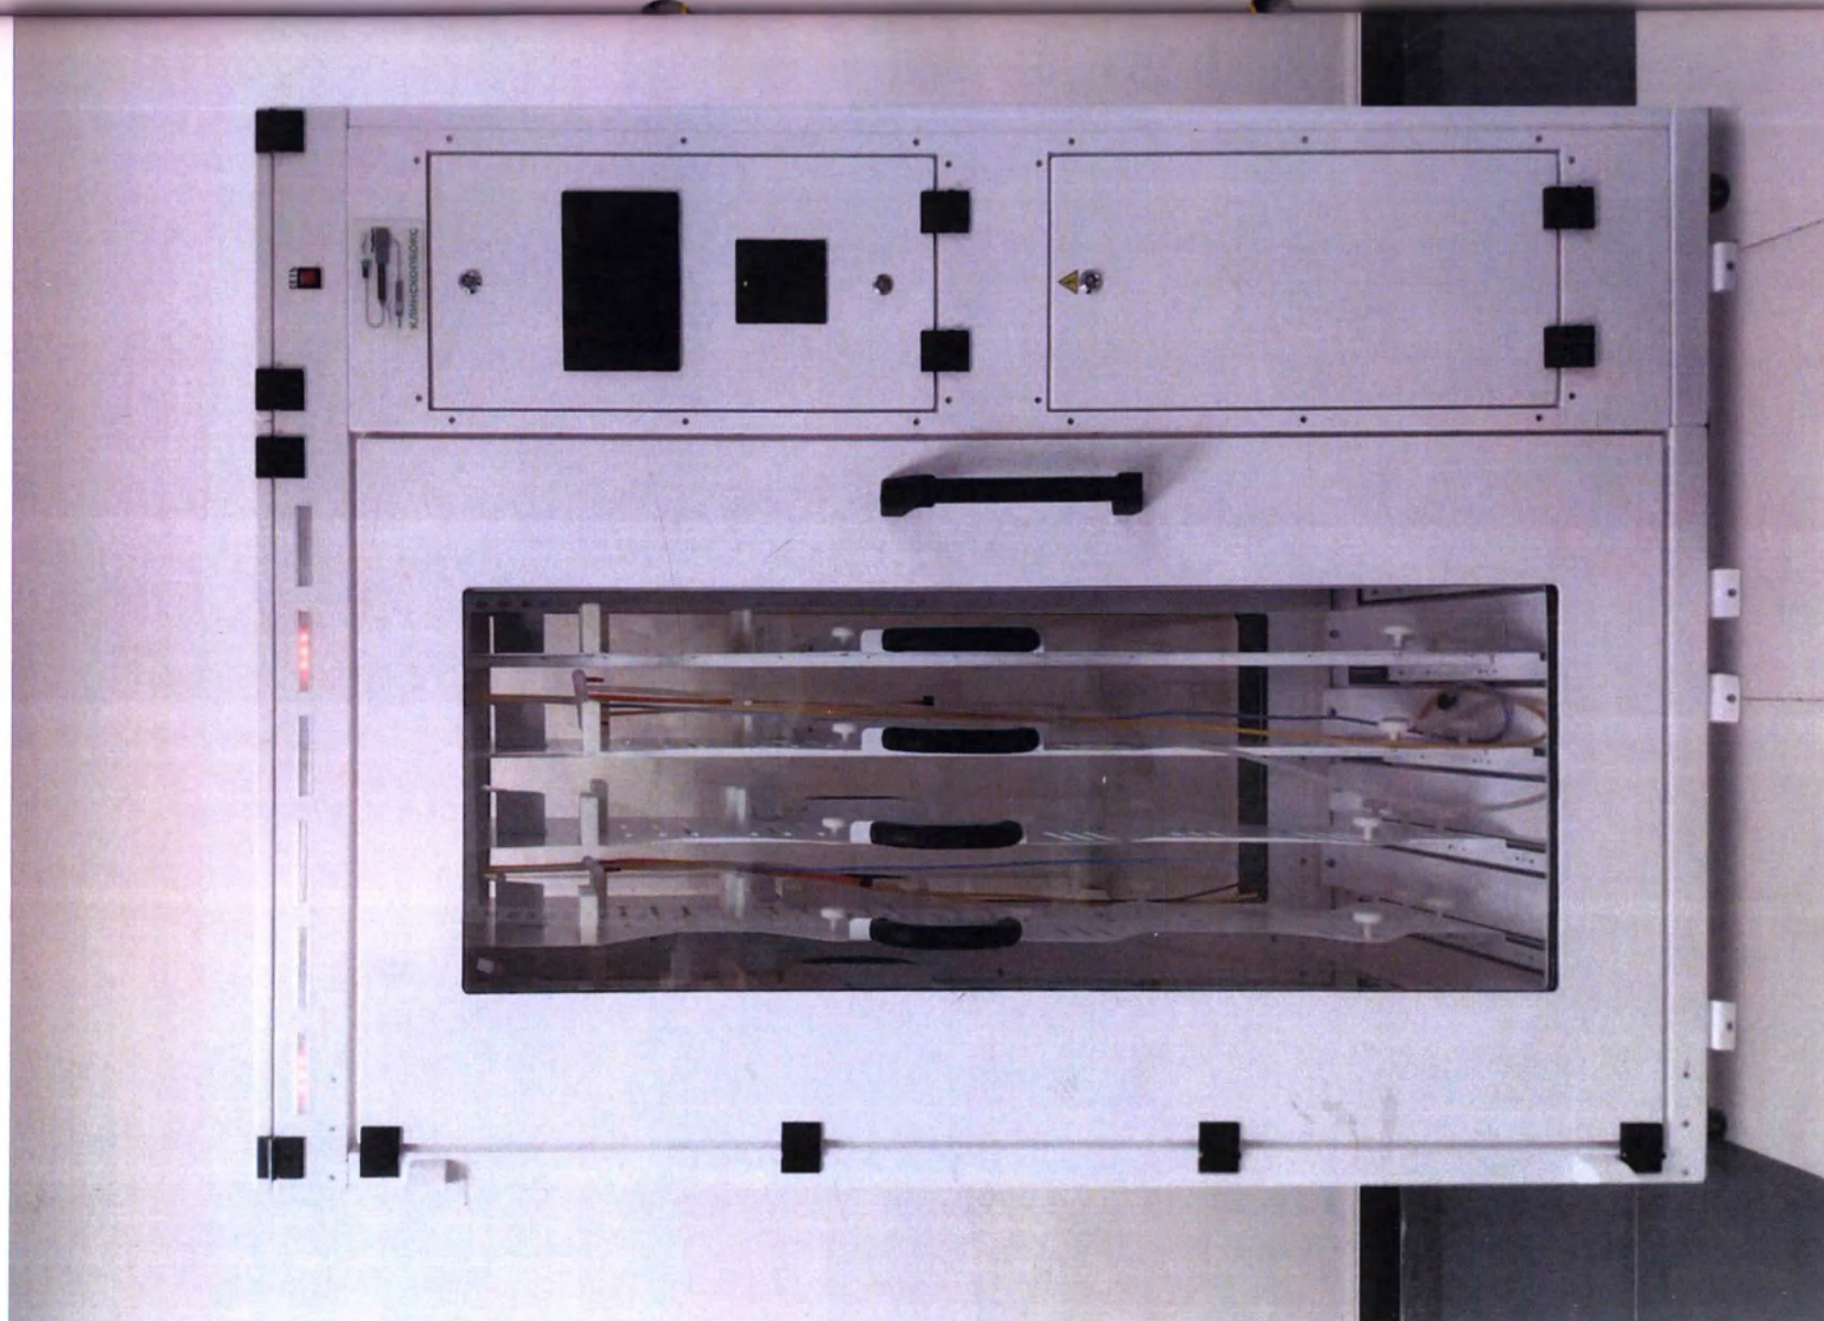


Фотографическое изображение №32. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Вид Шкафа с другой стороны.

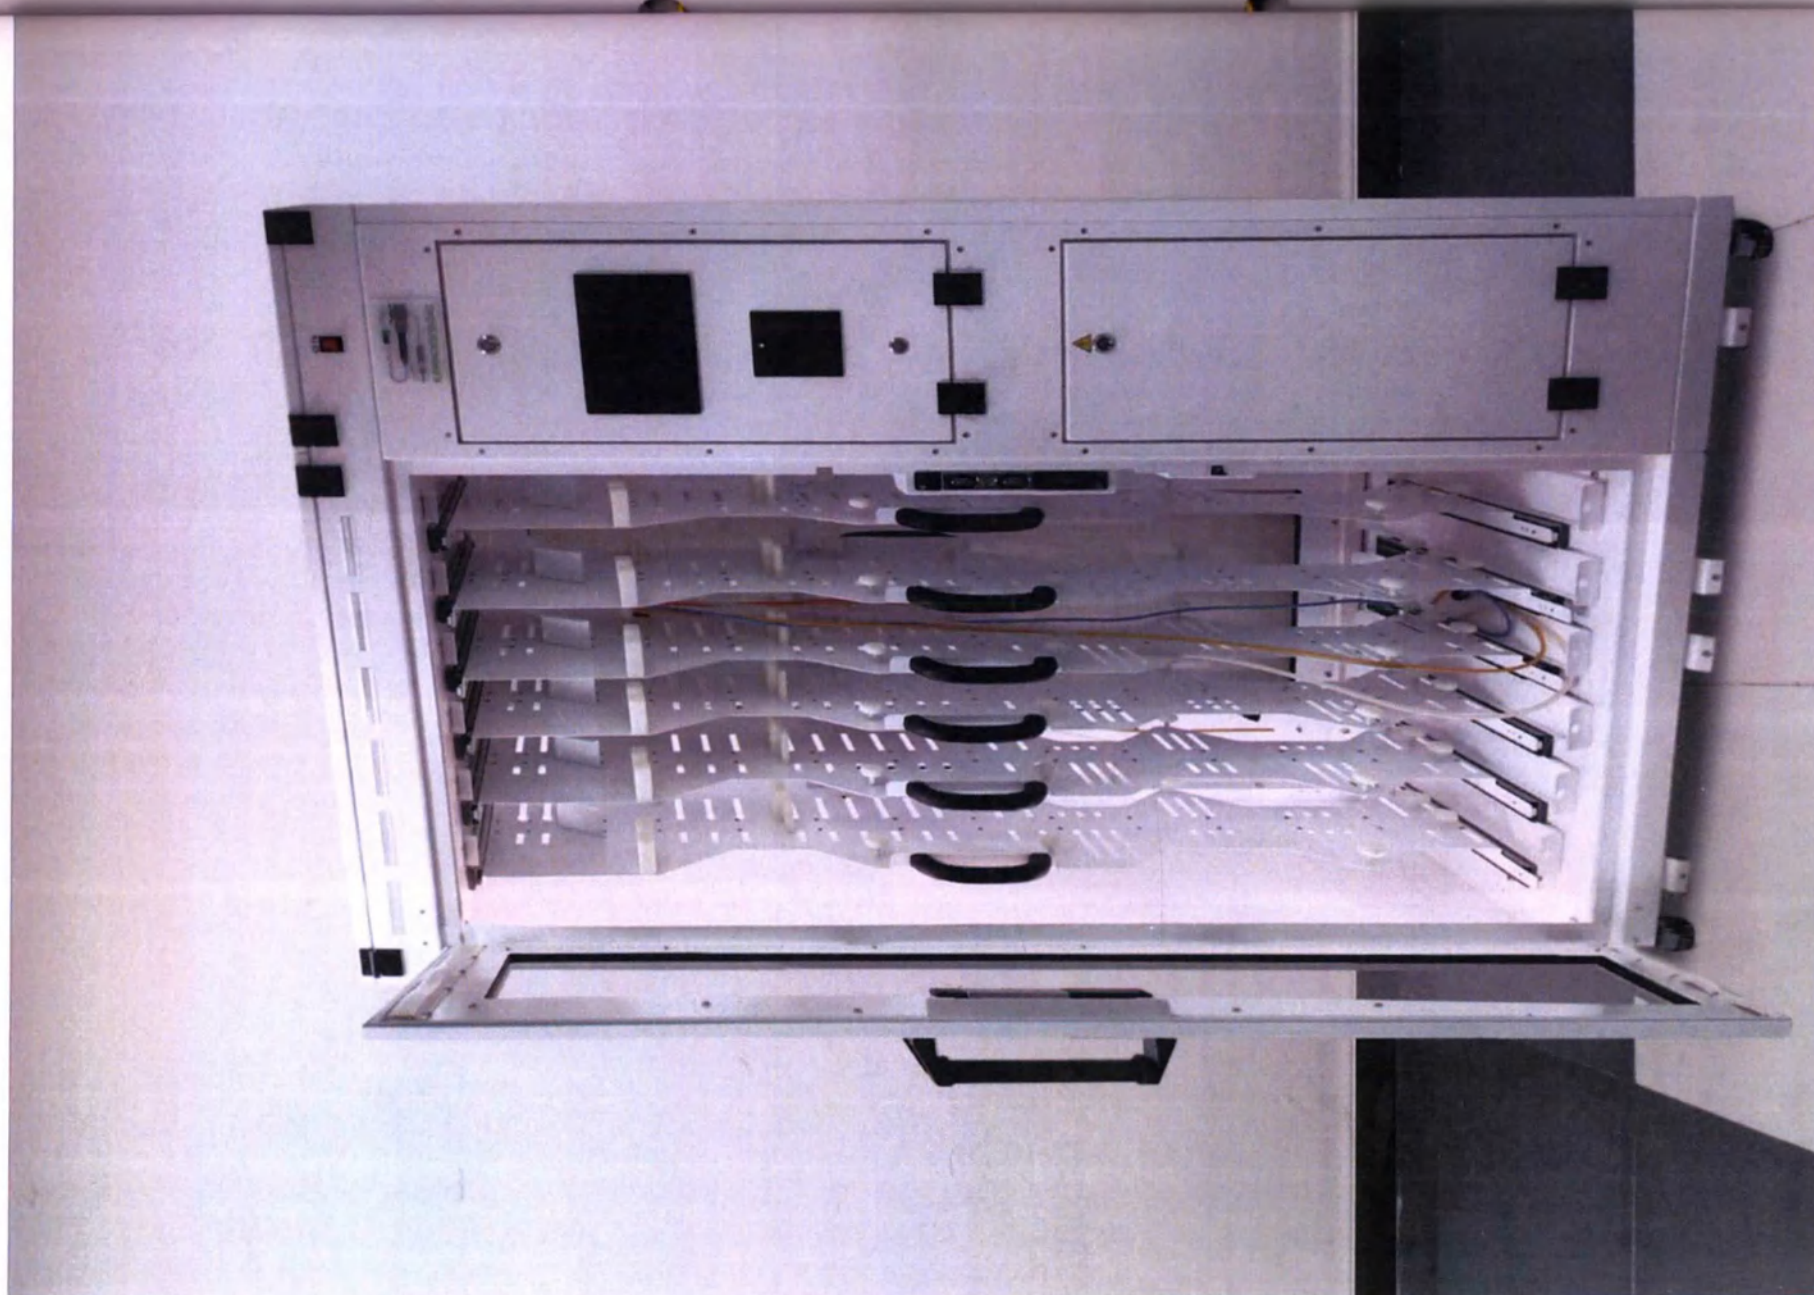


Фотографическое изображение №33. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Открыта дверь отсека хранения с другой стороны.

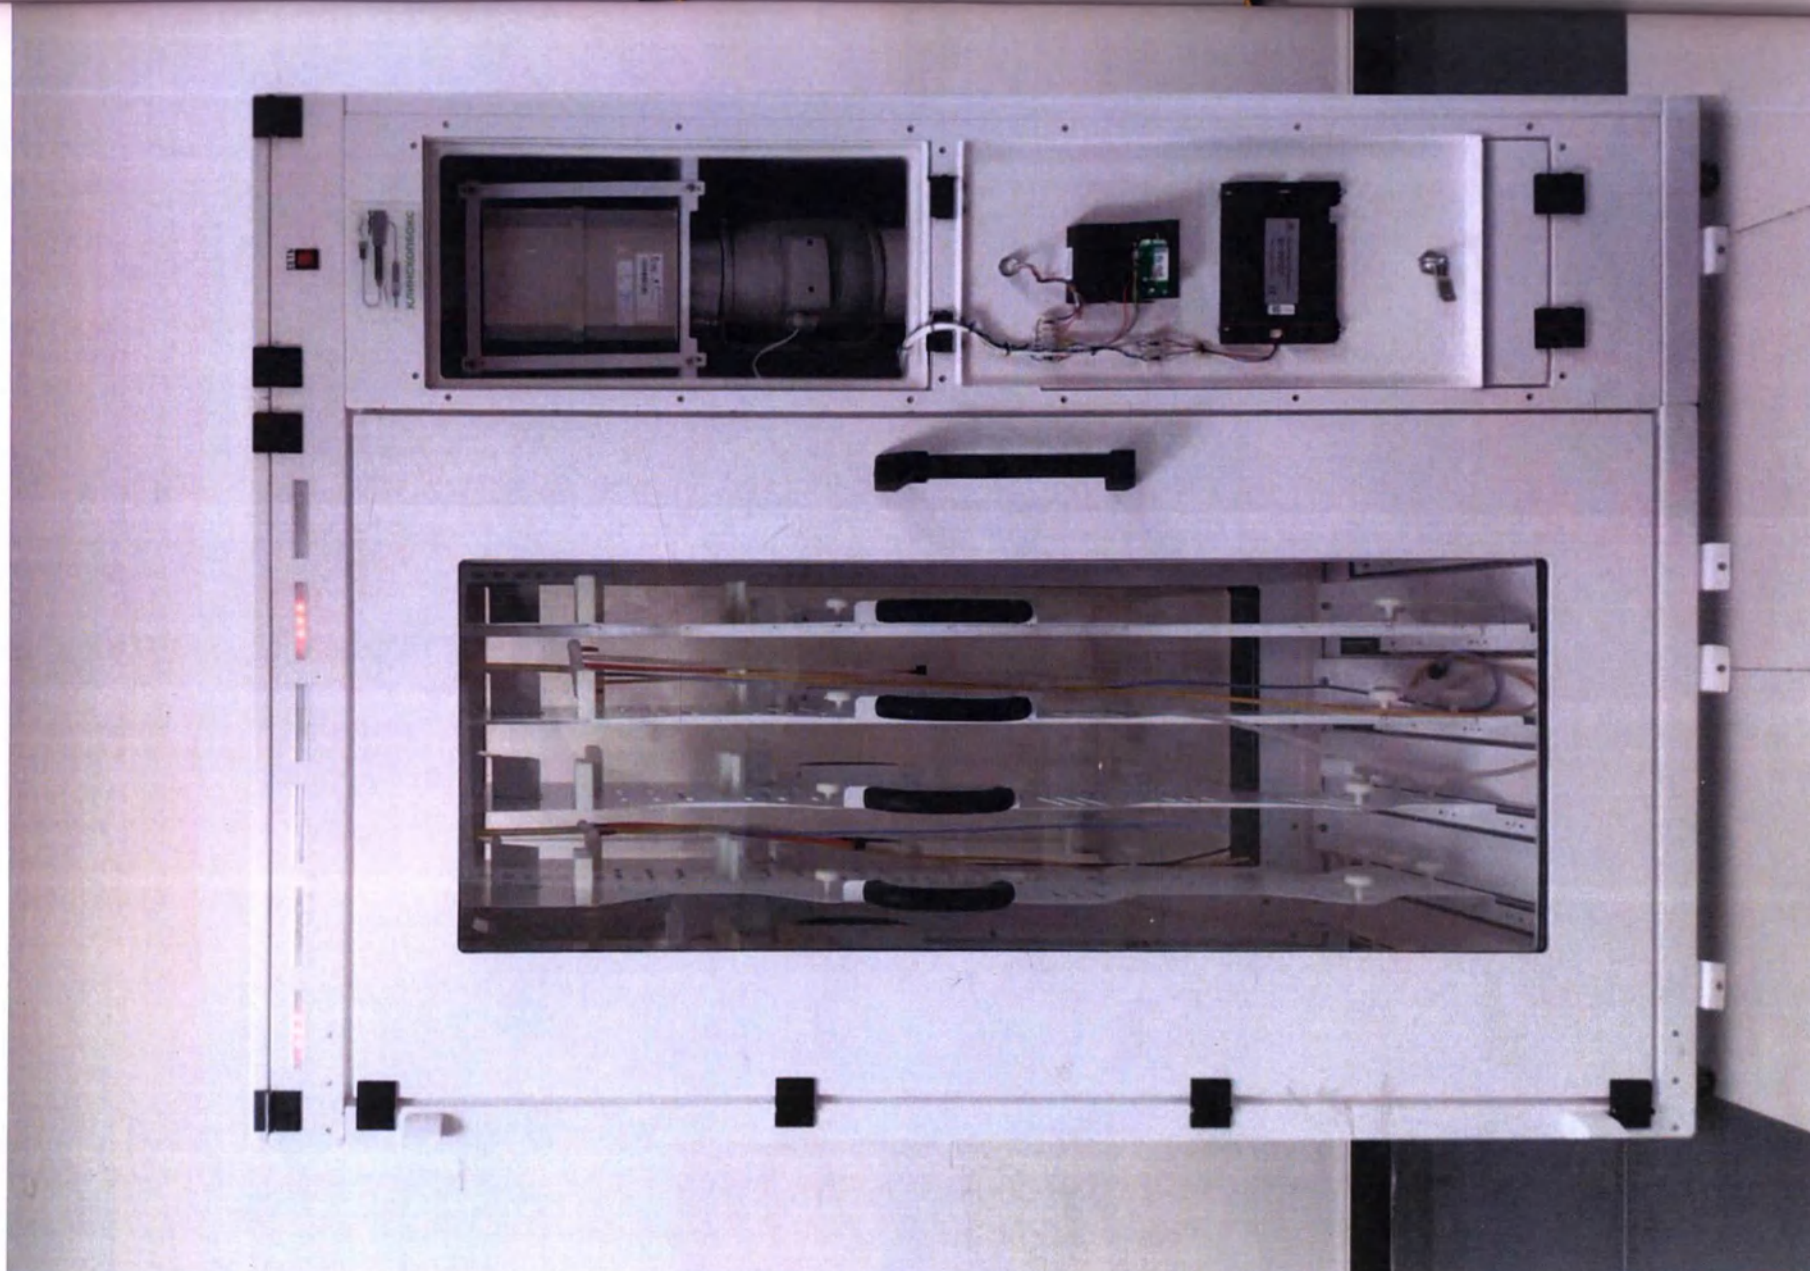


Фотографическое изображение №34. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Открыта дверь технического отсека с другой стороны.

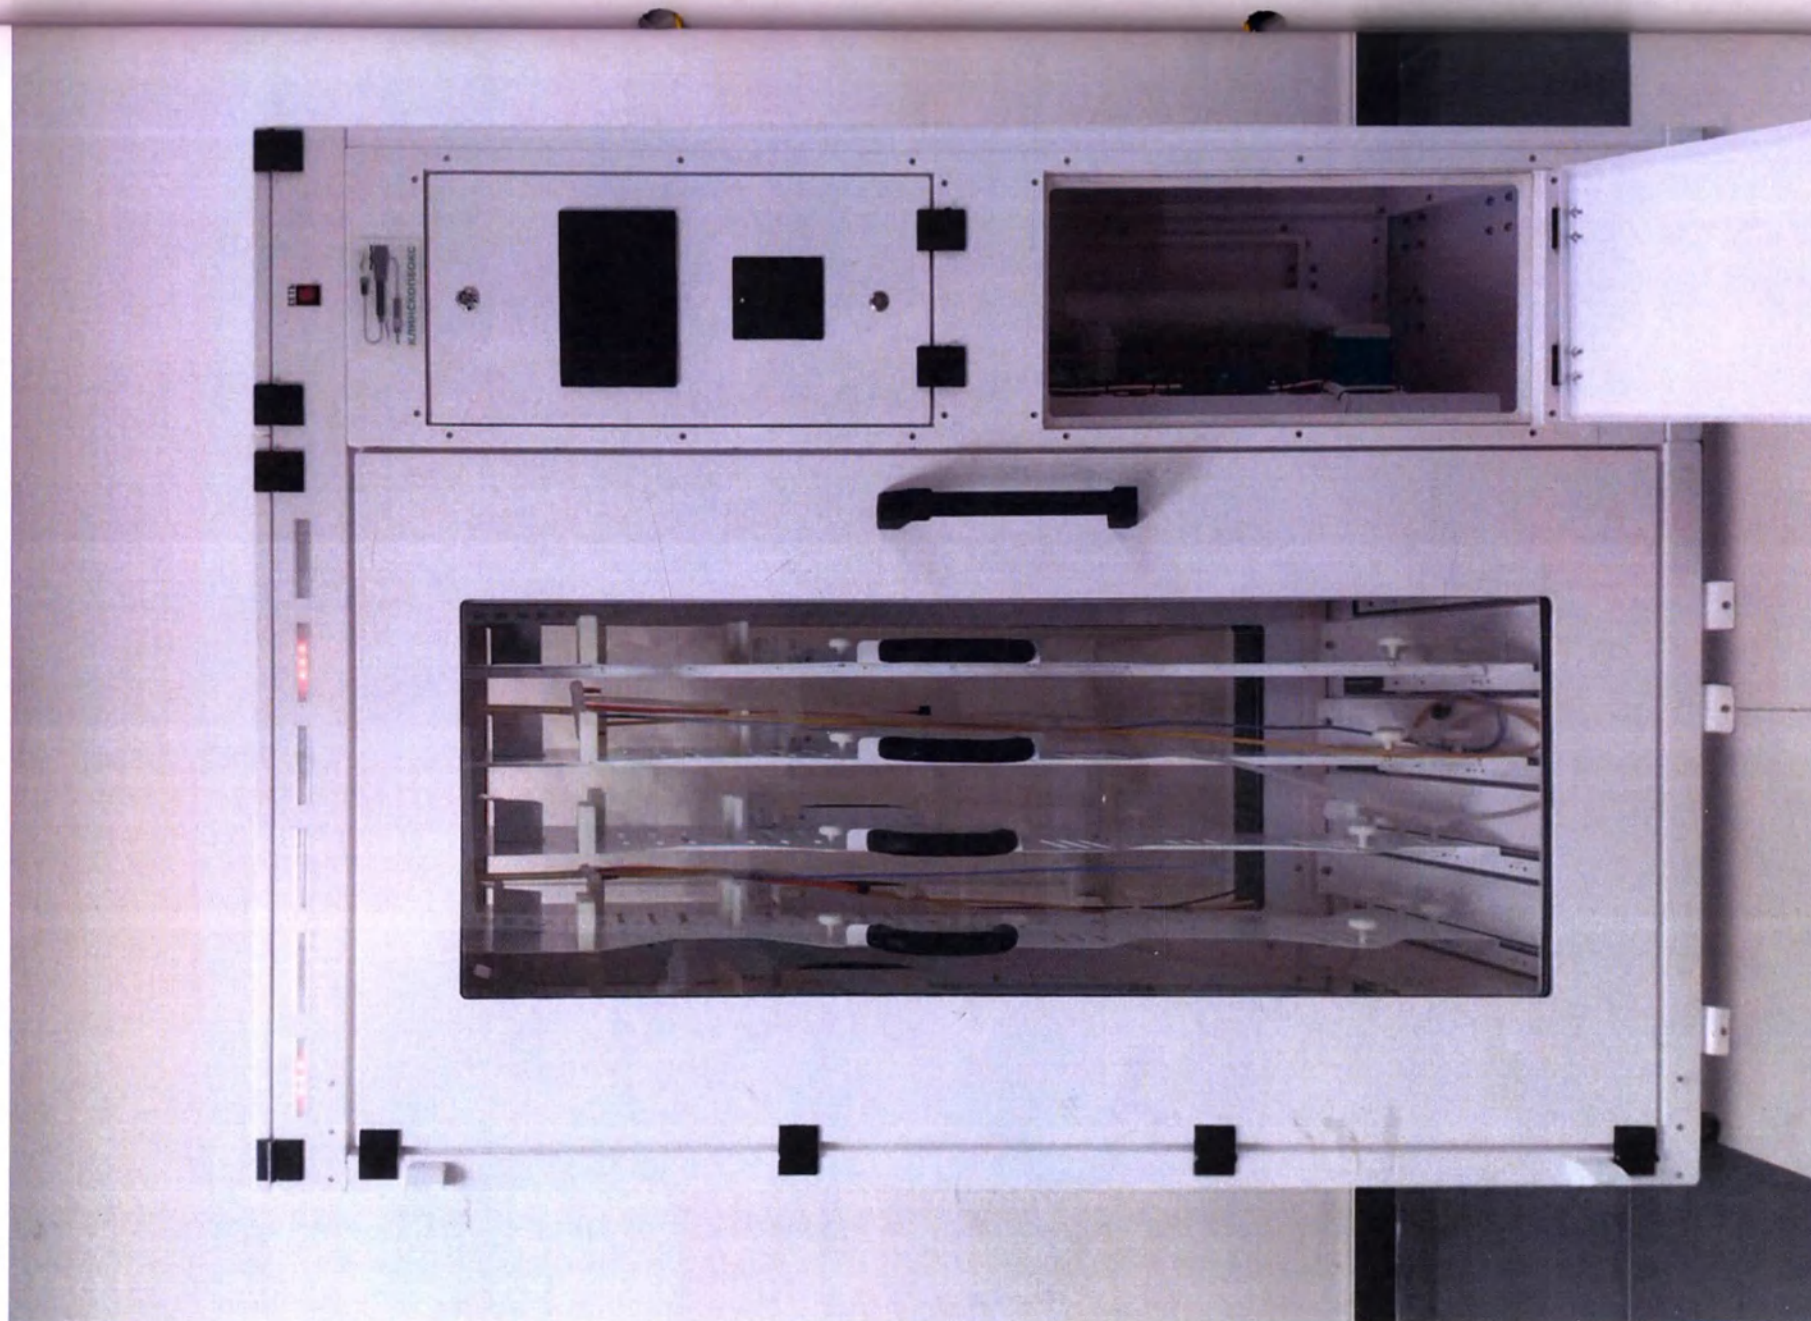

Фотографическое изображение №35. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Открыта дверь технического отсека с другой стороны.

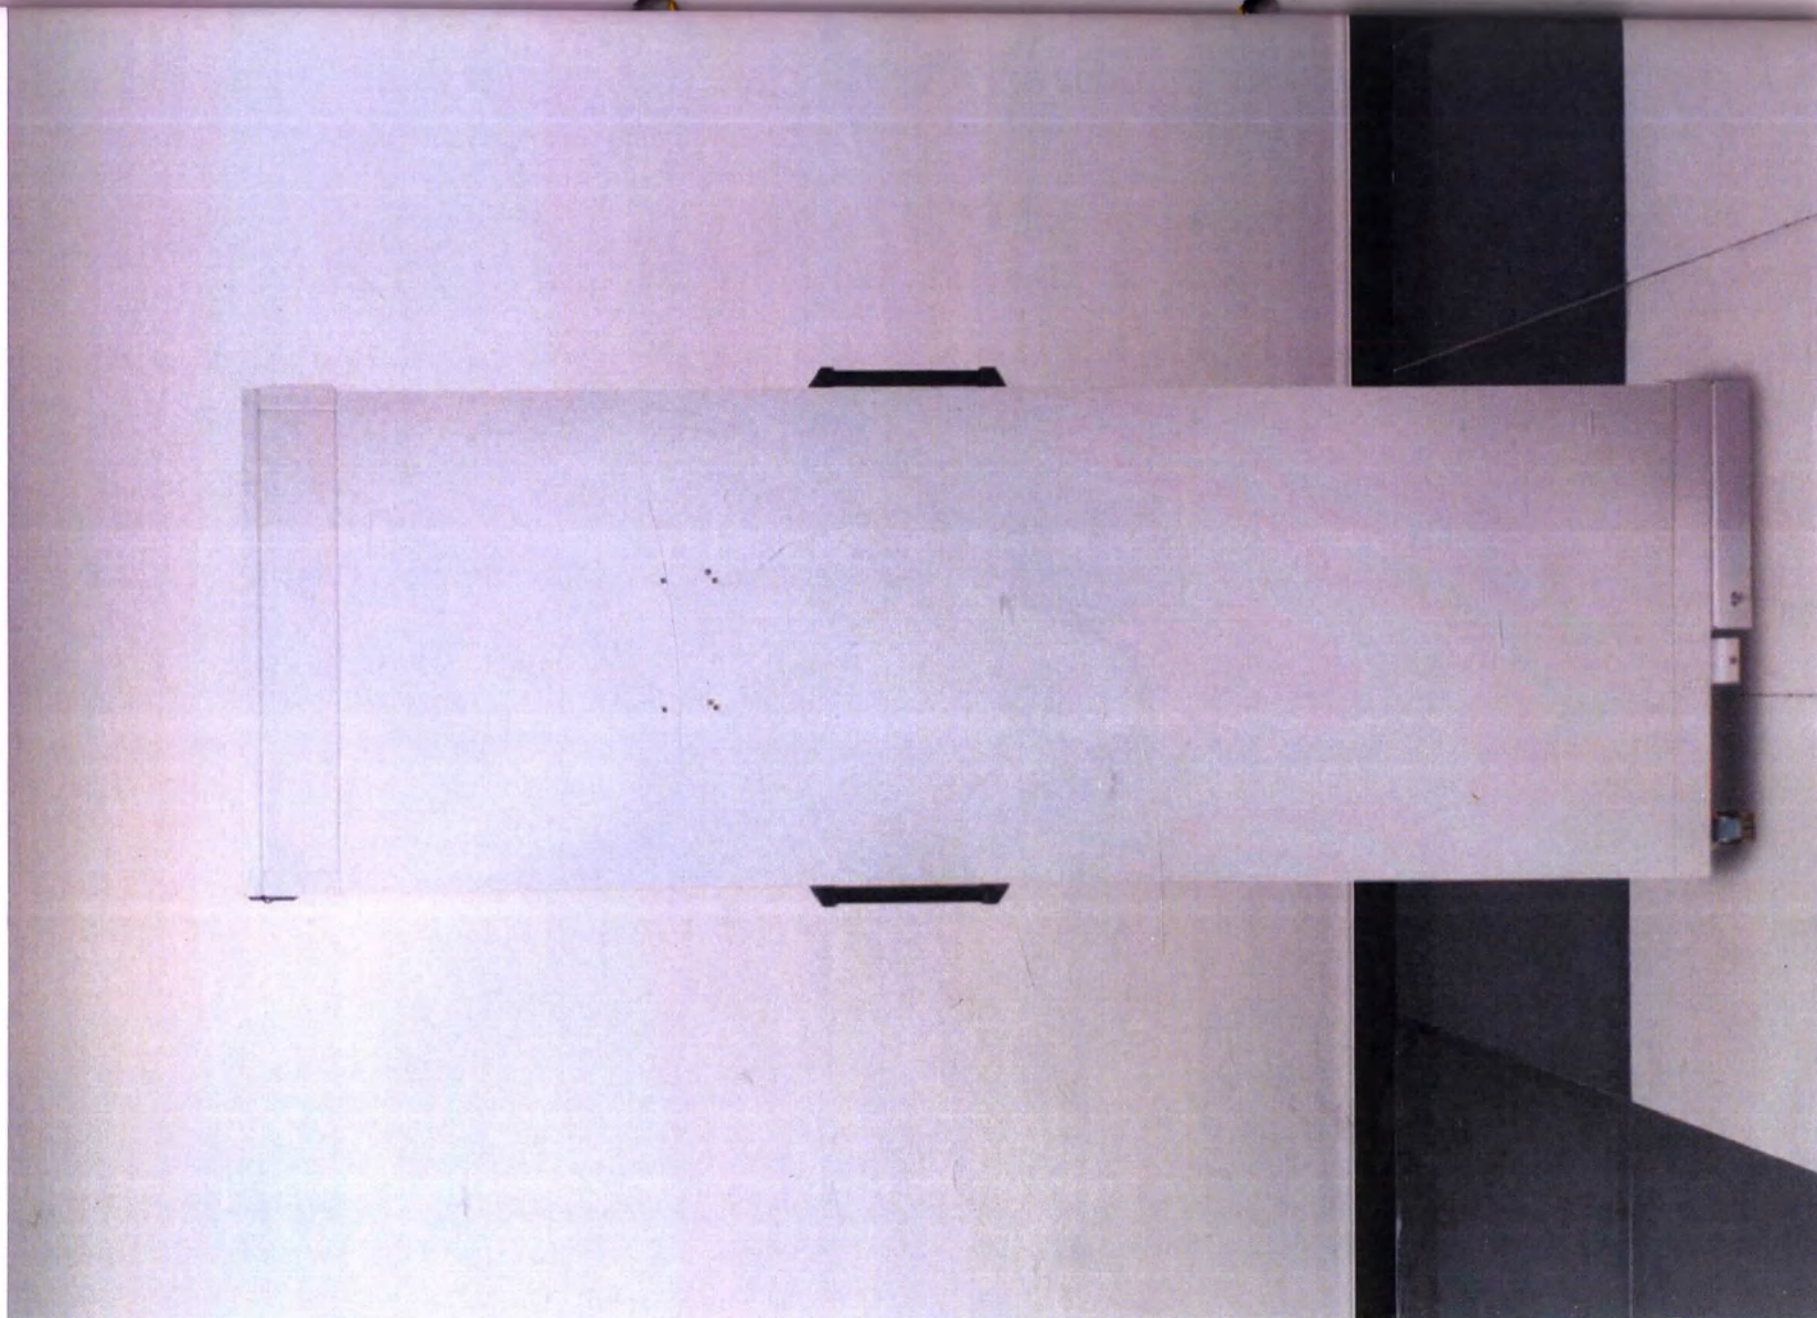

Фотографическое изображение №36. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Вид Шкафа с левого бока.

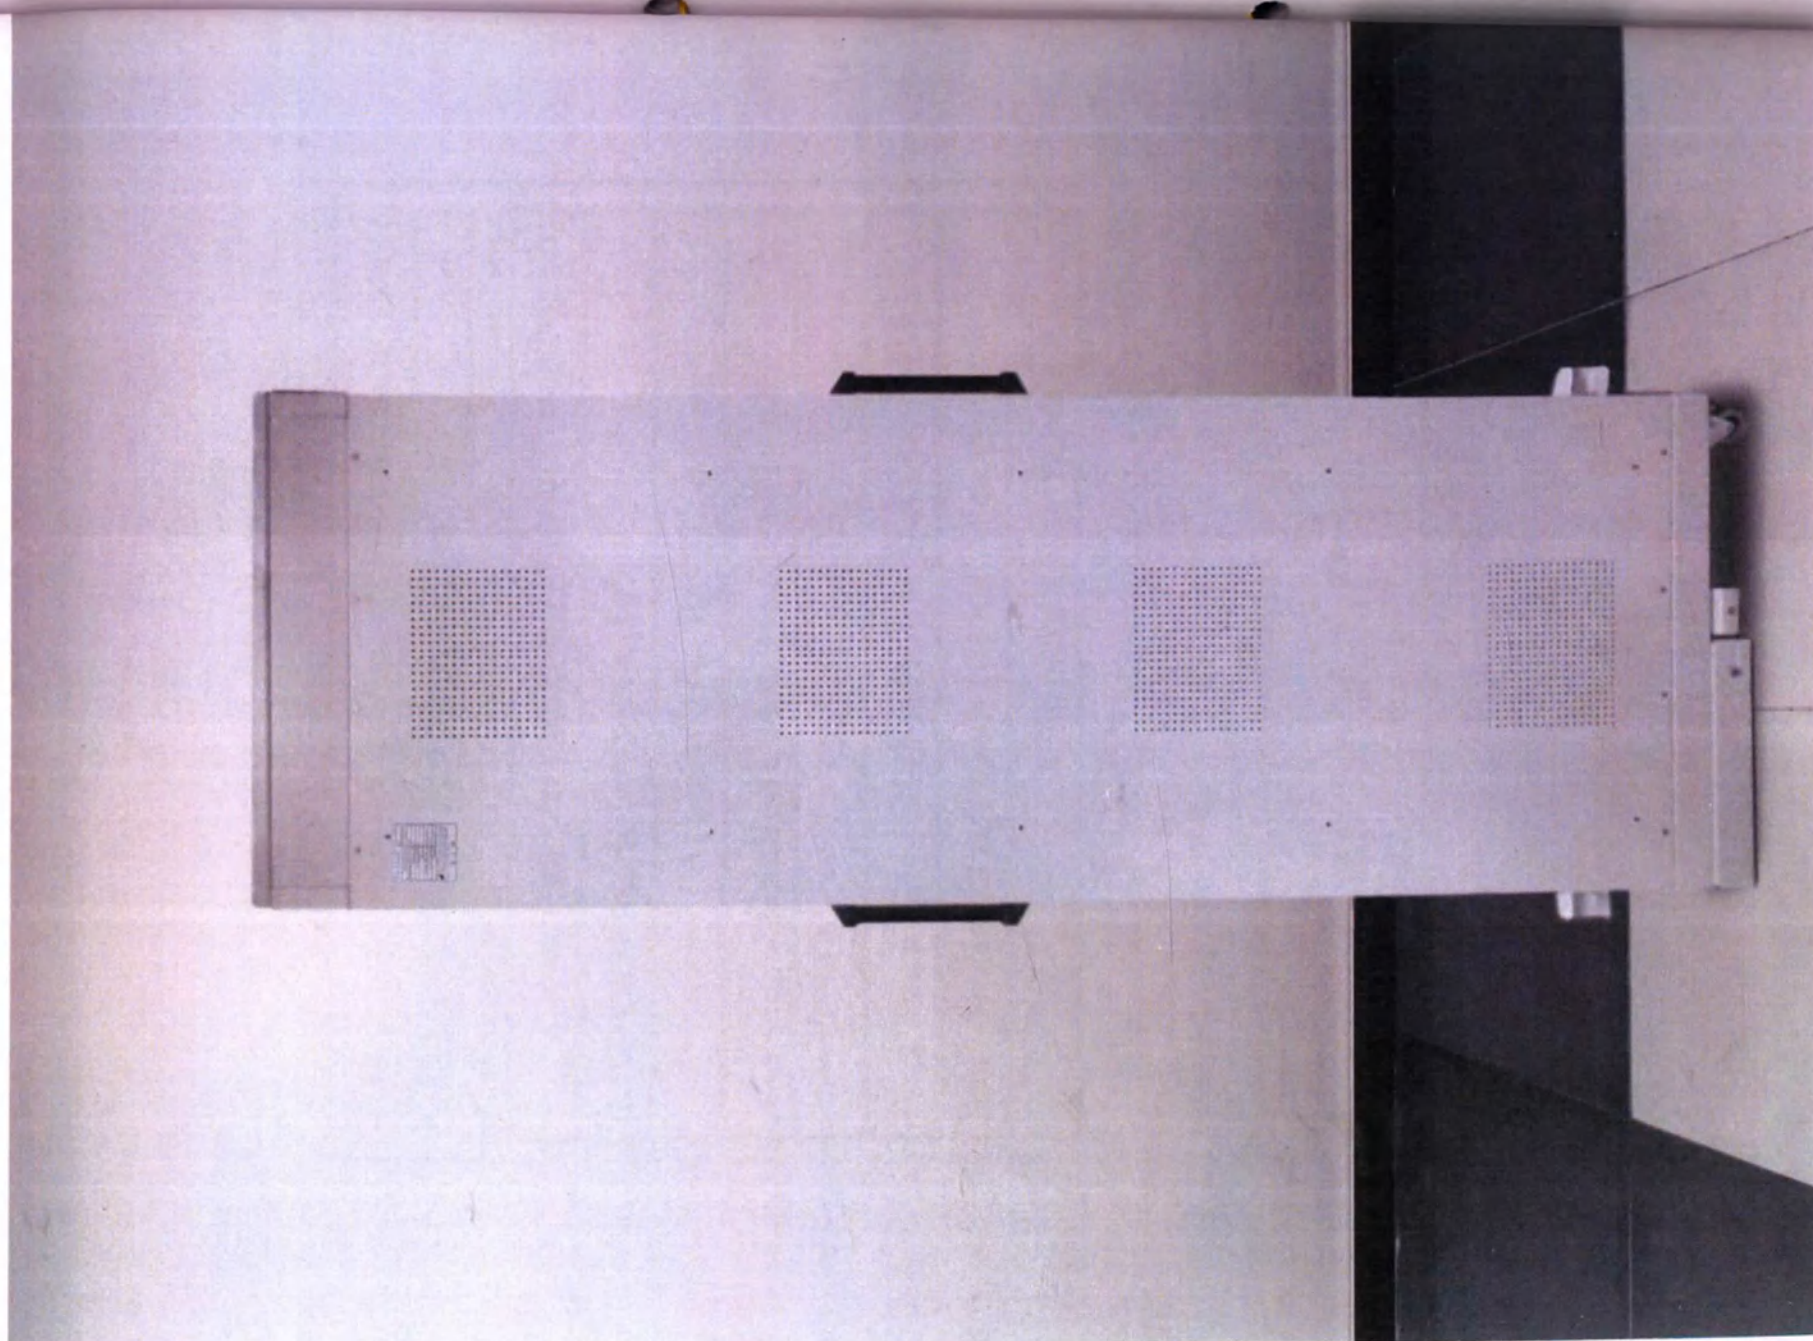

Фотографическое изображение №37. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Вид Шкафа с правого бока.

Фотографическое изображение №38. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Маркировка Шкафа.

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов

КЛИНСКОПБОКС

КЛИНСКОПБОКС-6ПРО

00004

Абсолютное решение хранения гибких эндоскопов в асептической среде

Вариант исполнения	КЛИНСКОПБОКС-6ПРО
Напряжение, В/Частота, Гц	~230/50
Мощность, Вт	310
Степень защиты	IP10
Масса, кг	280
Габариты (ШхГхВ), мм	1340x810x1958,50
Дата изготовления	07.2023г.
Сборщик	Сантатин Р.З.

ТУ 12.50.50-601-40718084-2023

Пронизовитель: ООО "ЦБГ", Россия, 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная д.2, стр.6. Ям 20. Тел: +7-991-591-77-97, эл почта: cbg.msk@yandex.ru.

Место производства: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Монтаньяков д.8

Условия эксплуатации при температуре от +10 до +40 °С, влажность до 80%.


Использовать изделие утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

г/у № от " " 20 год

↑↑

⊗

ⓘ

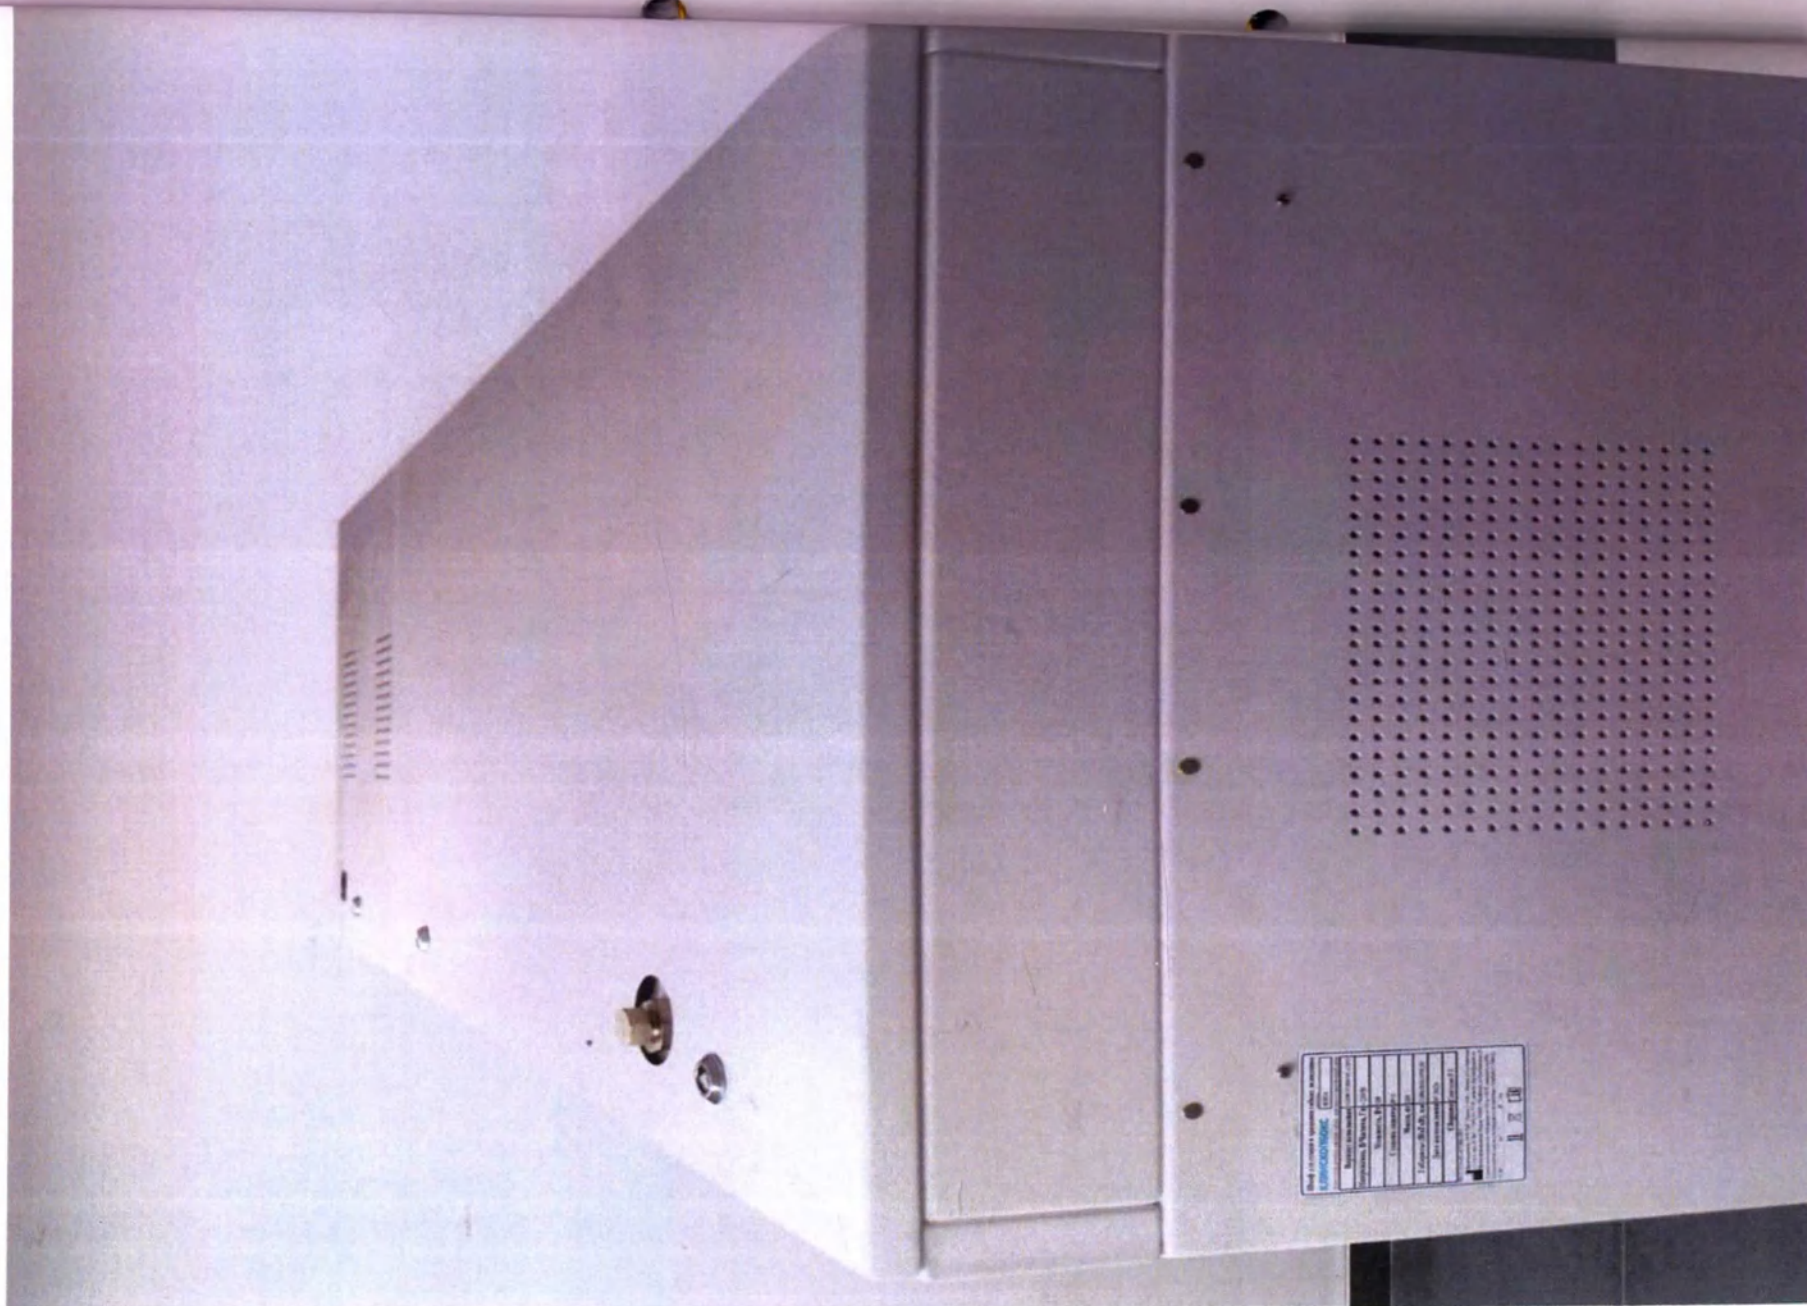


Фотографическое изображение №39. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Верхняя крышка технического отсека.




Фотографическое изображение №40. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-6ПРО. Открыта верхняя крышка технического отсека.




Фотографическое изображение №41. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Вид Шкафа спереди с одной стороны.

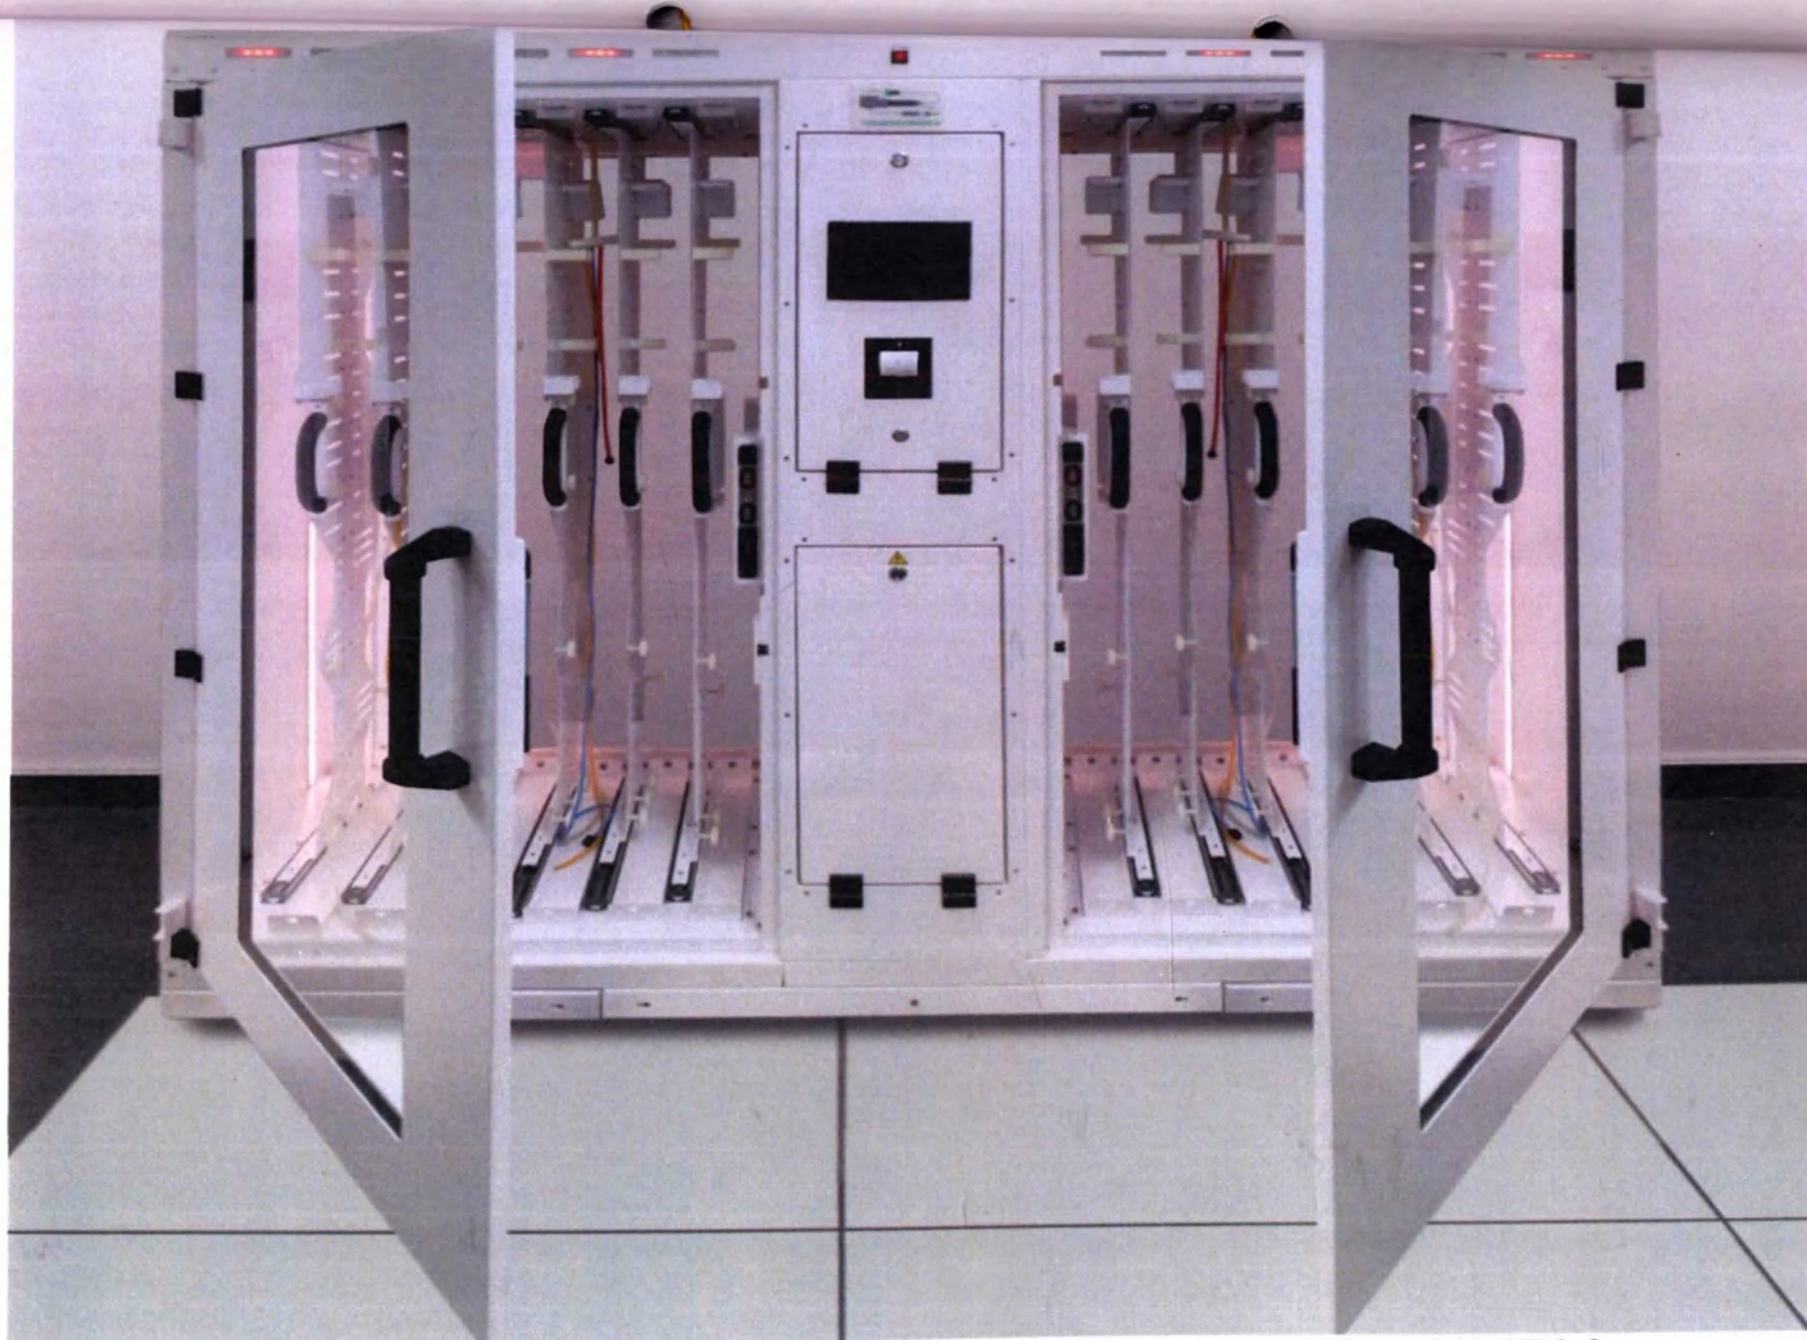


Фотографическое изображение №42. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыты двери отсека хранения с одной стороны.

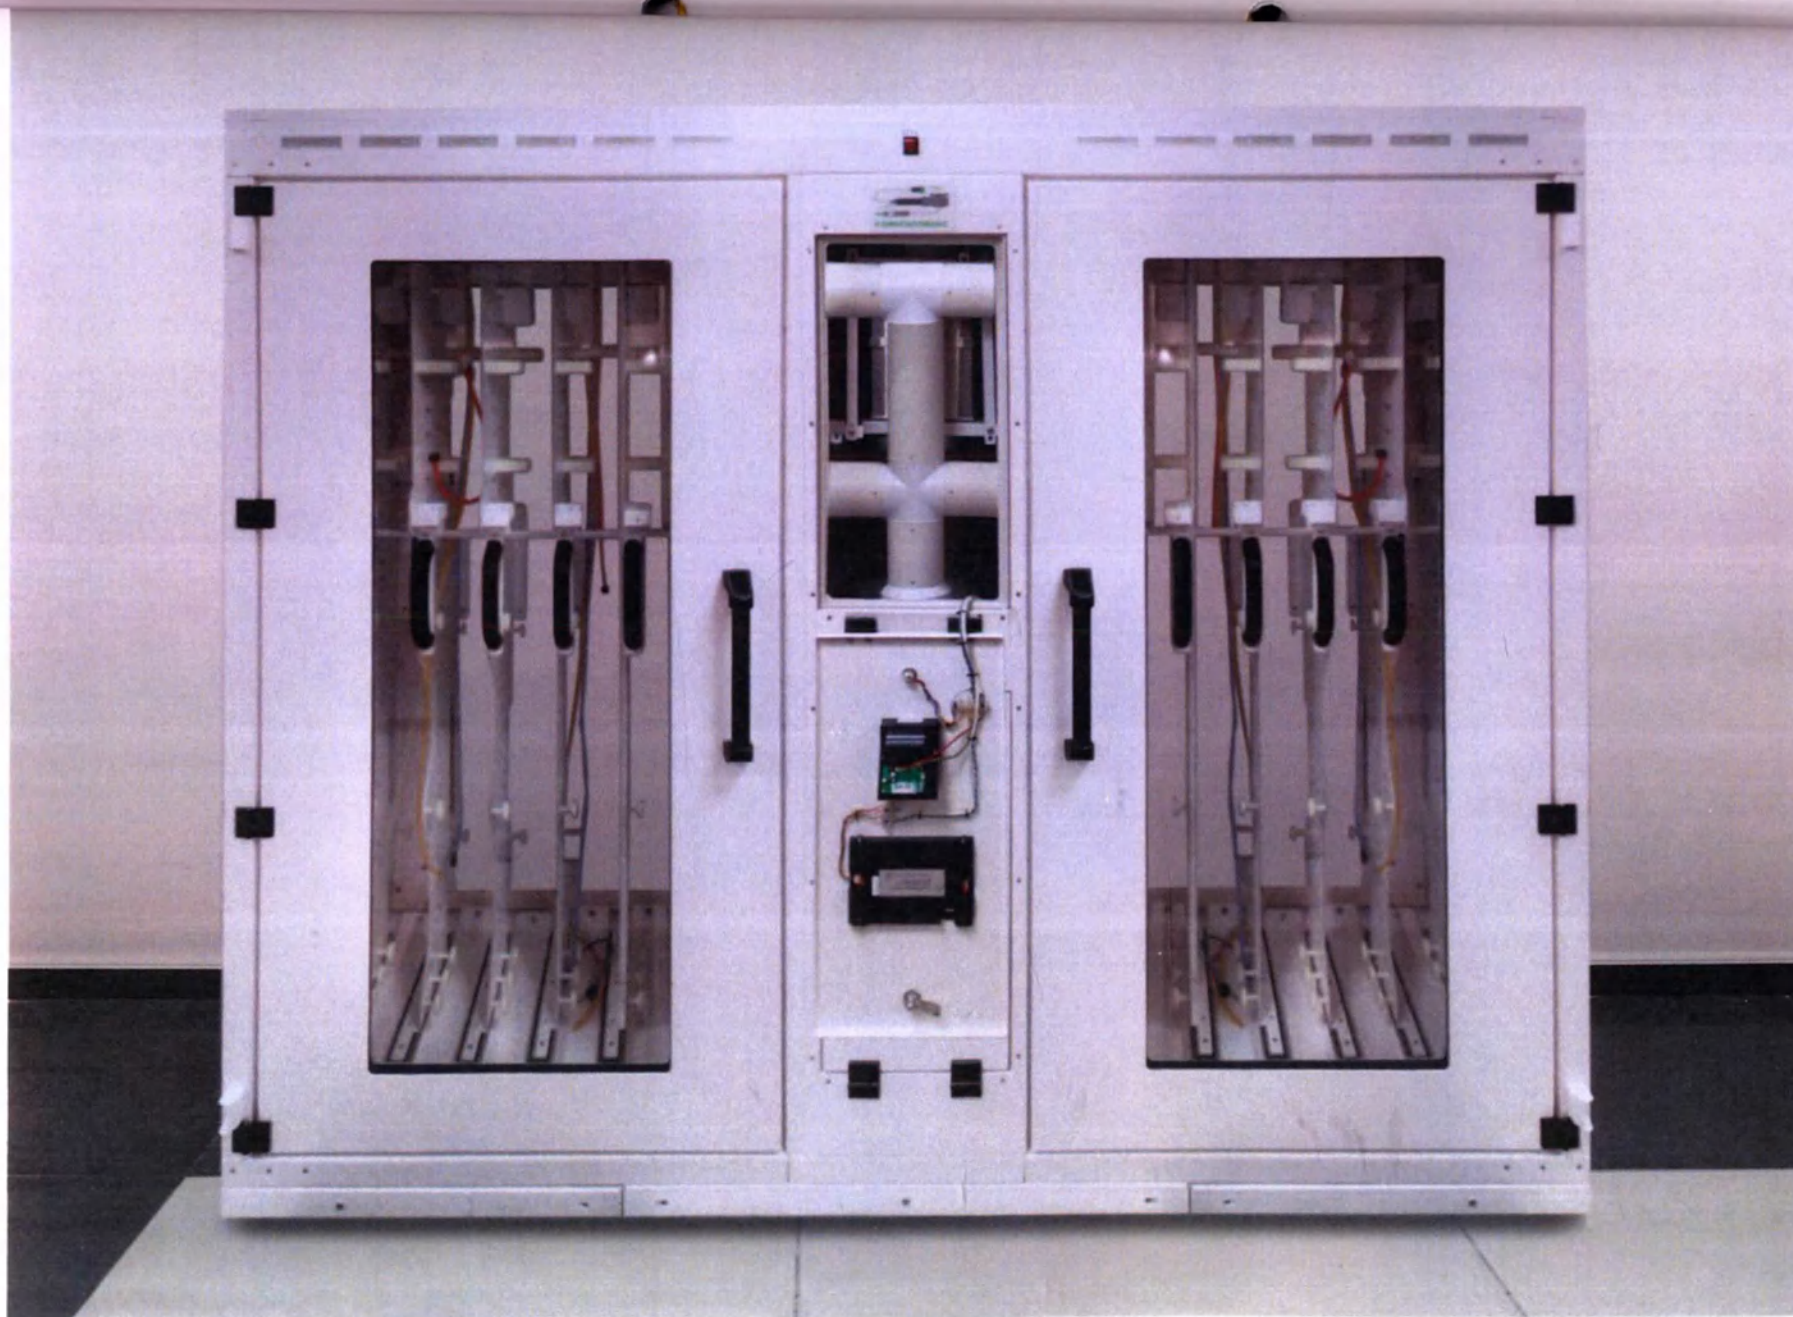


Фотографическое изображение №43. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыта дверь технического отсека с одной стороны.

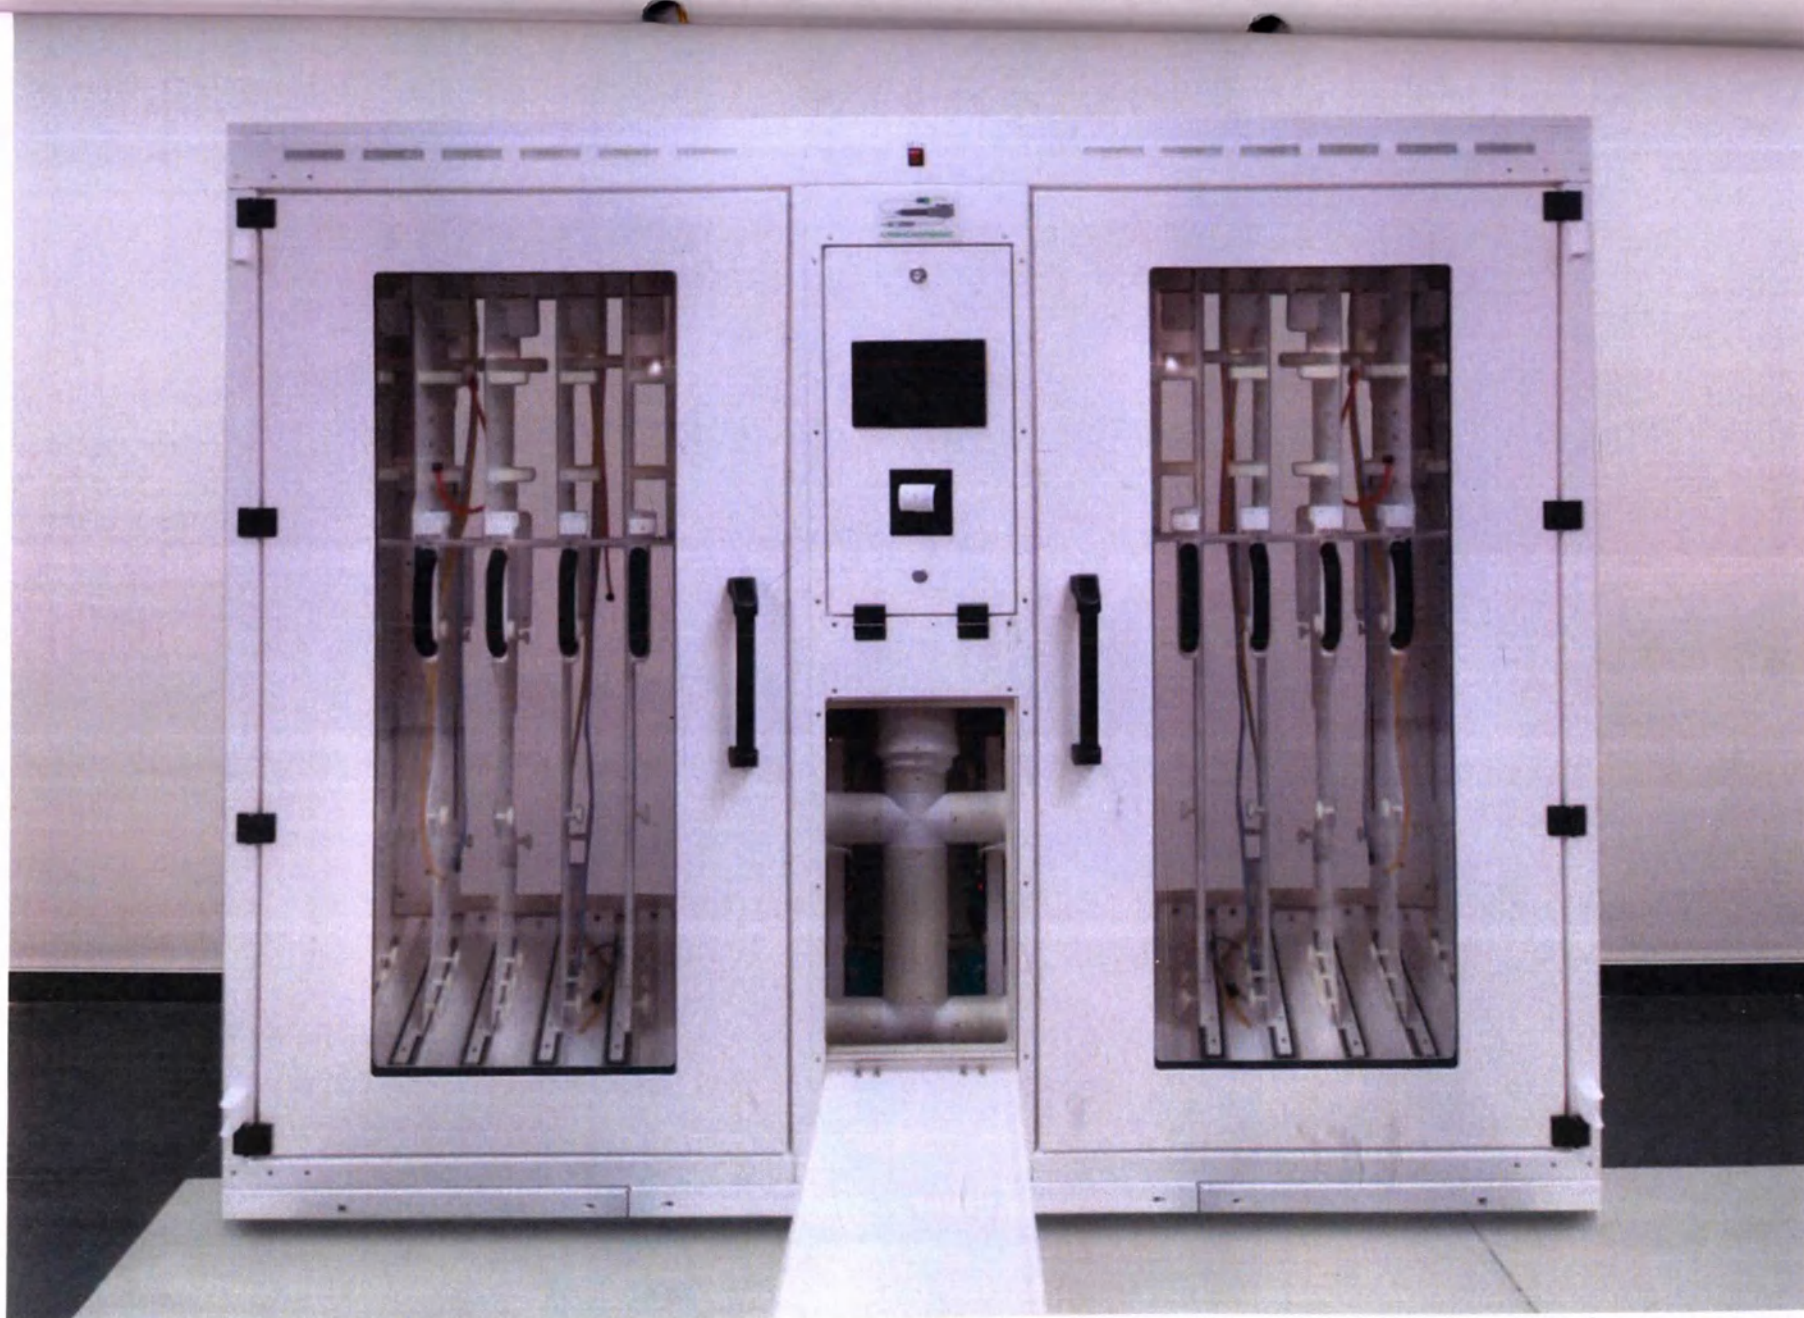


Фотографическое изображение №44. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыта дверь технического отсека с одной стороны.

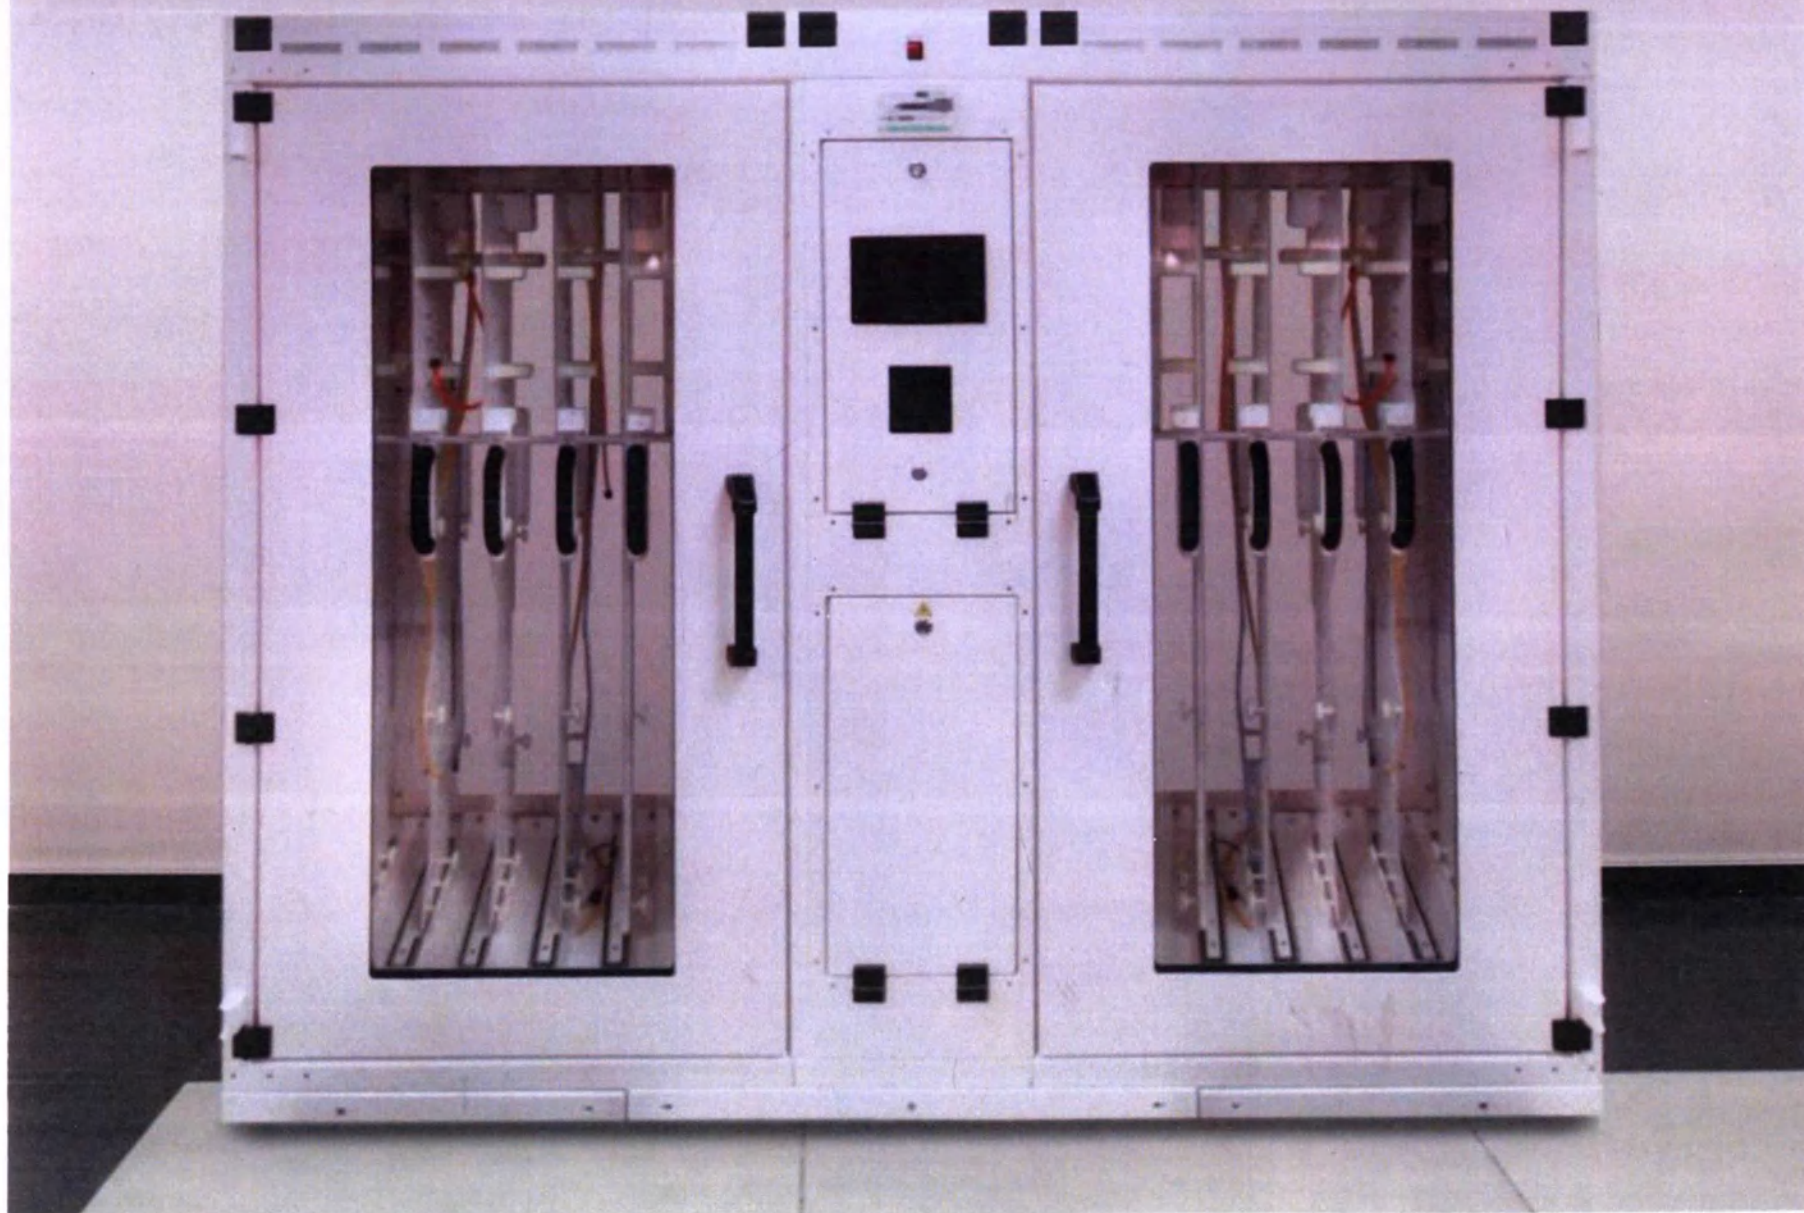


Фотографическое изображение №45. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Вид Шкафа с другой стороны.

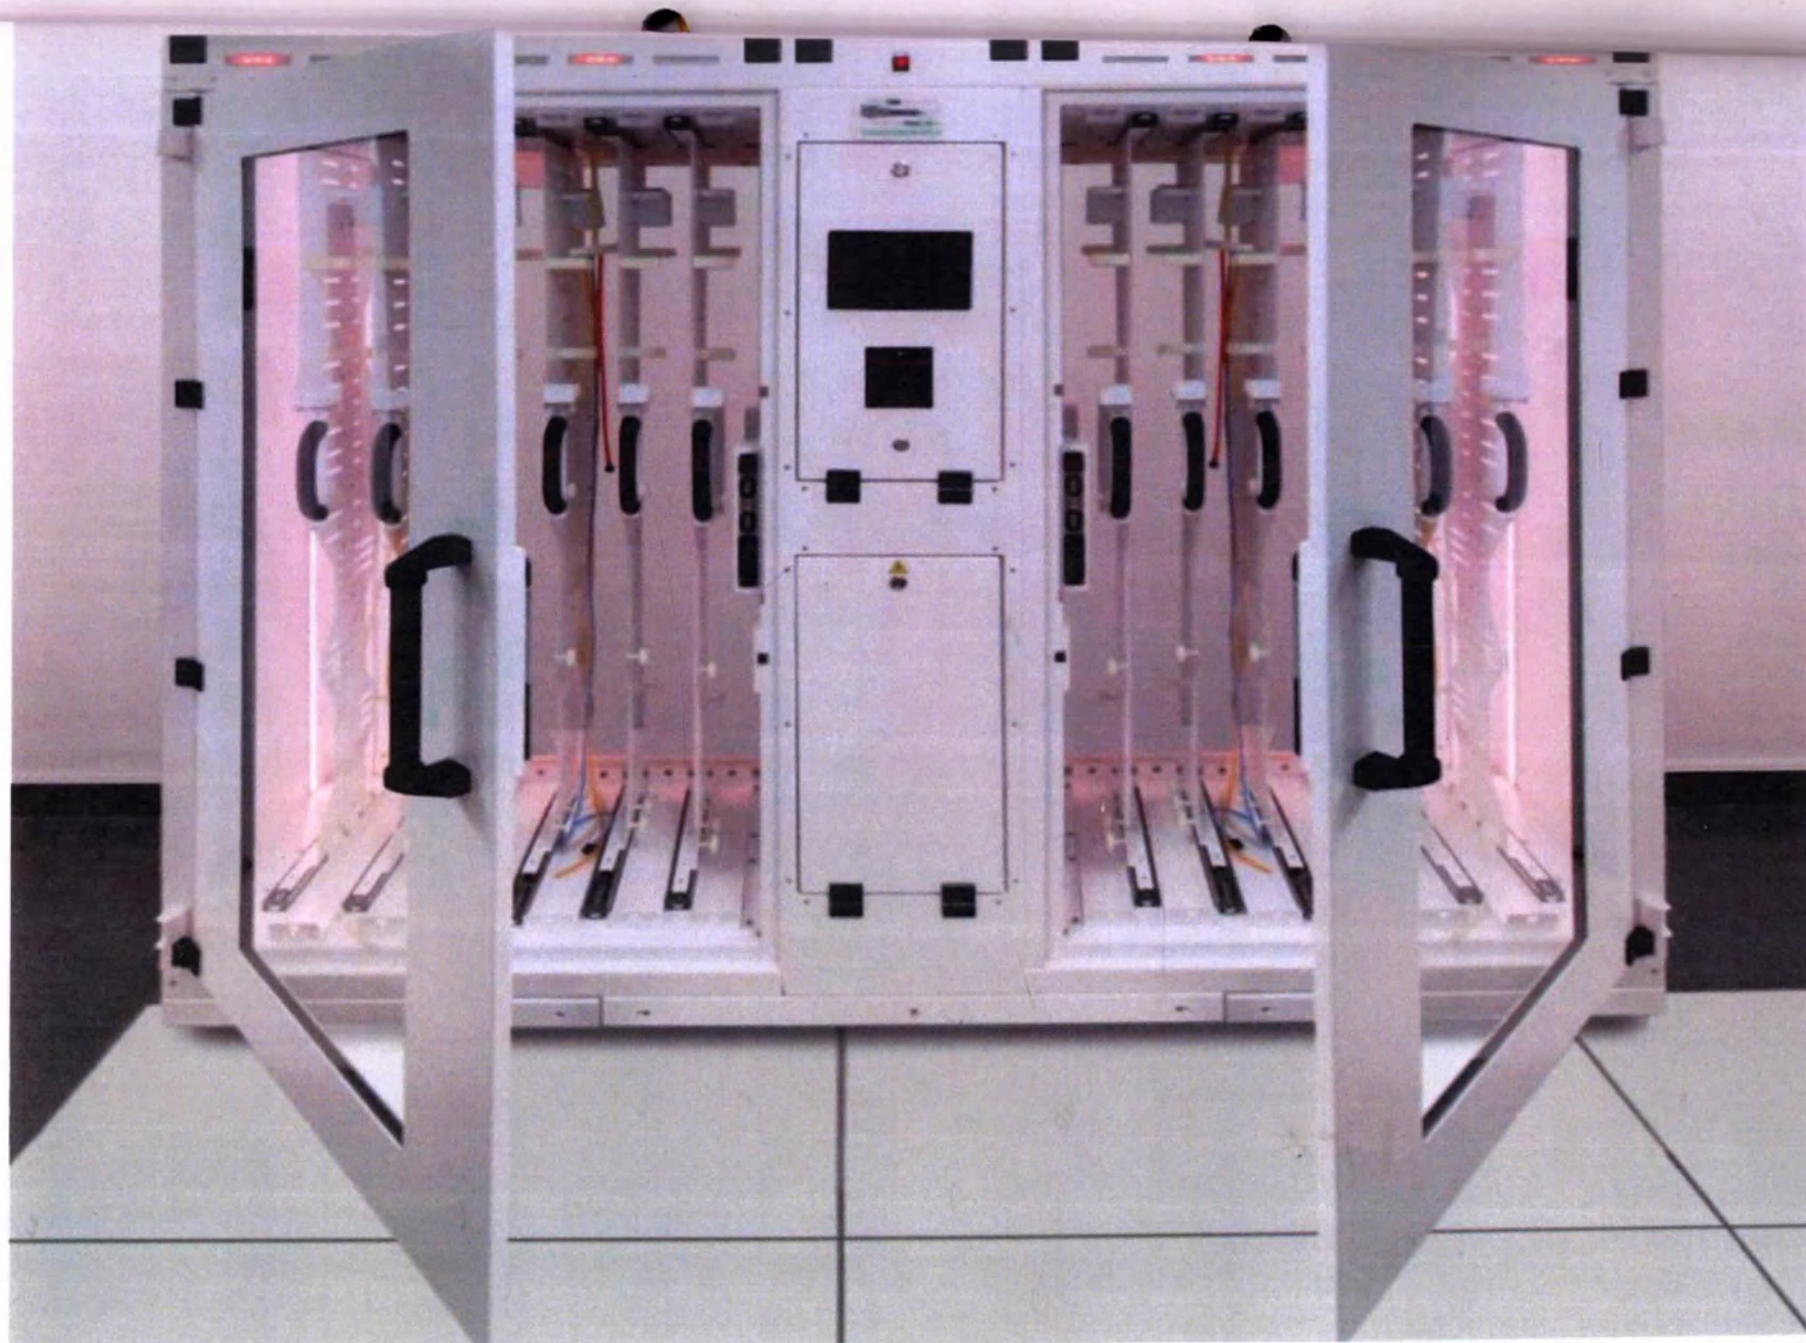


Фотографическое изображение №46. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыты двери отсека хранения с другой стороны.

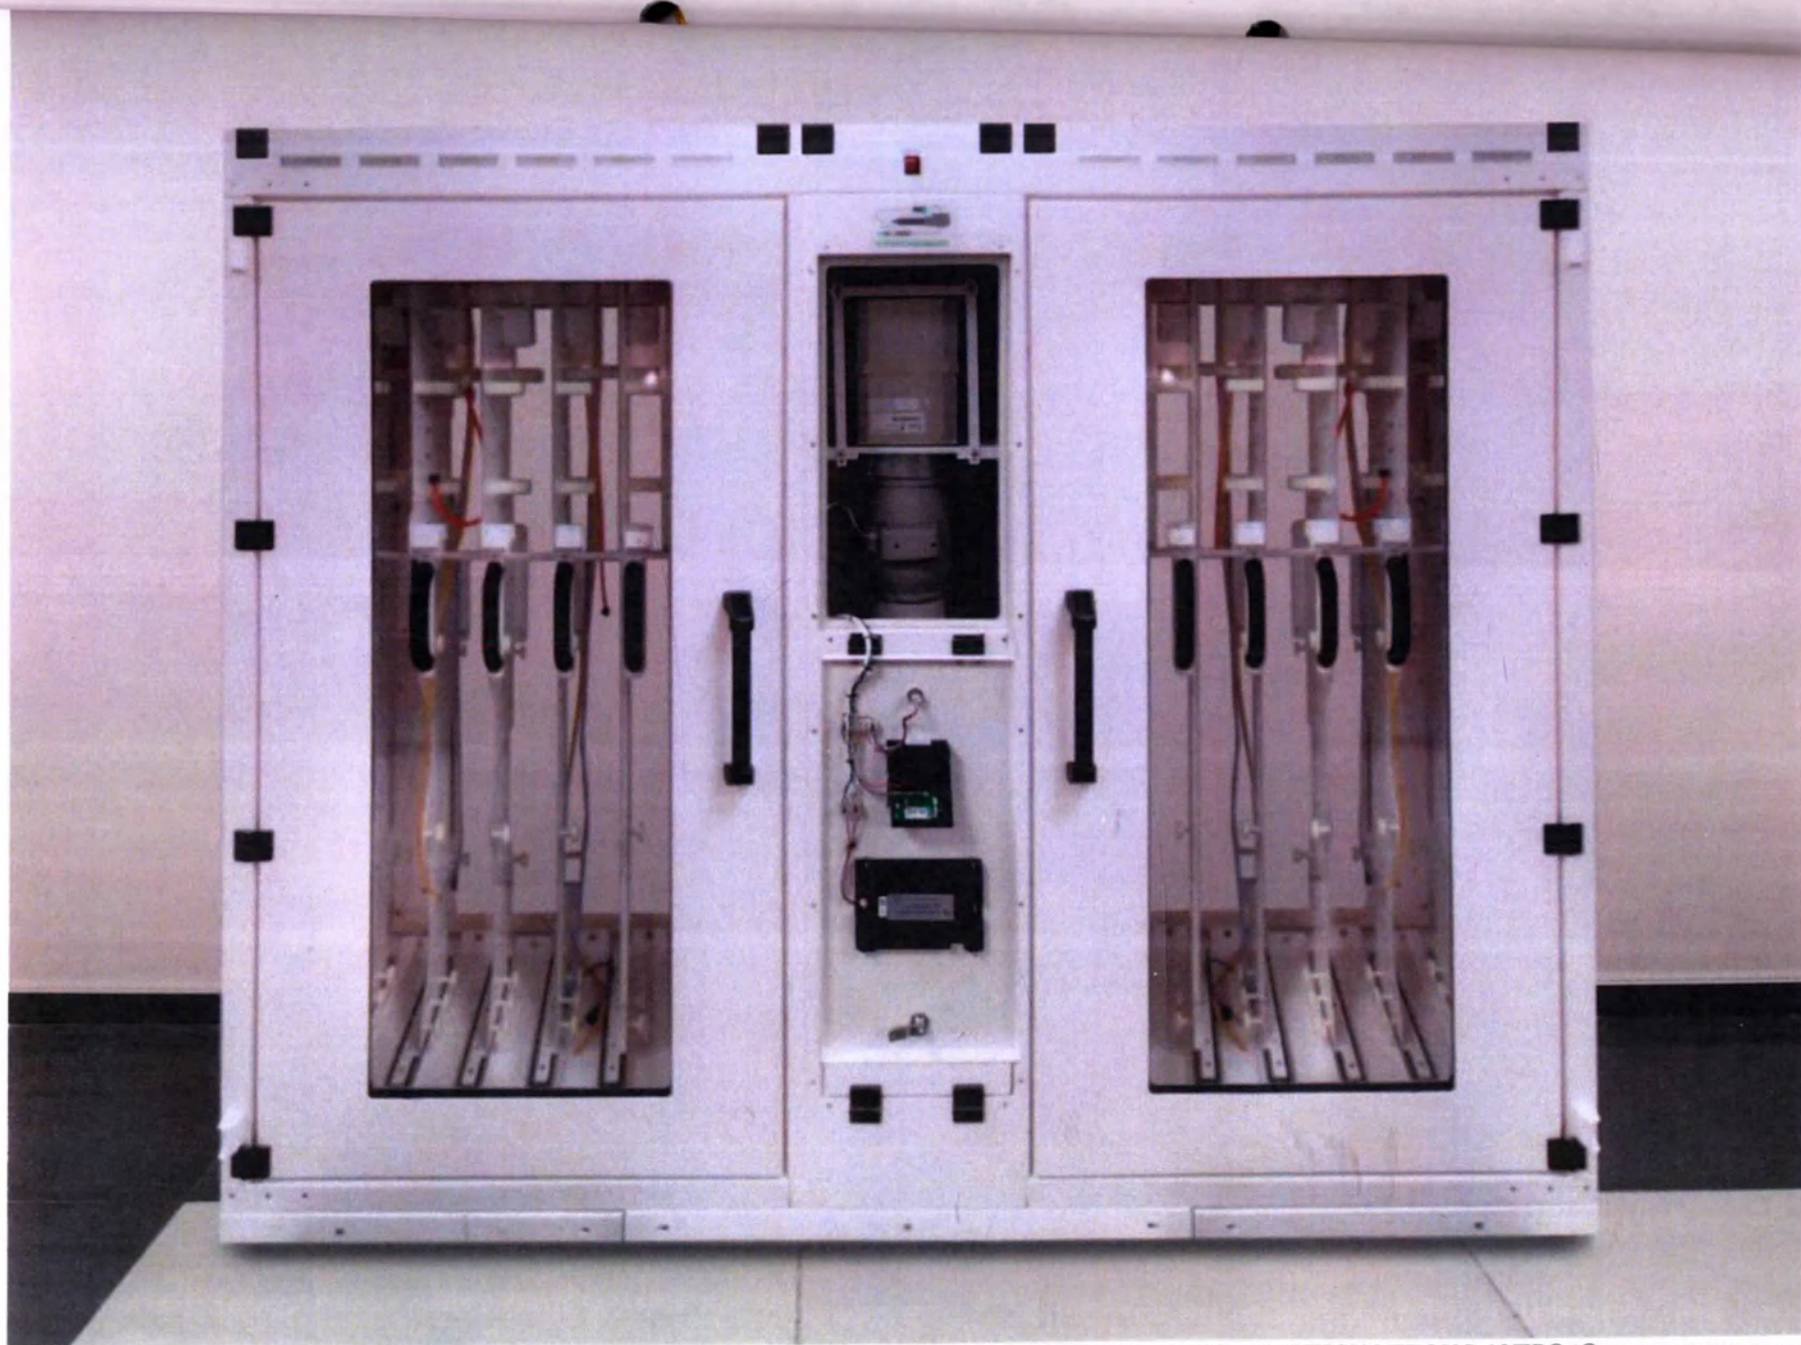


Фотографическое изображение №47. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыта дверь технического отсека с другой стороны.

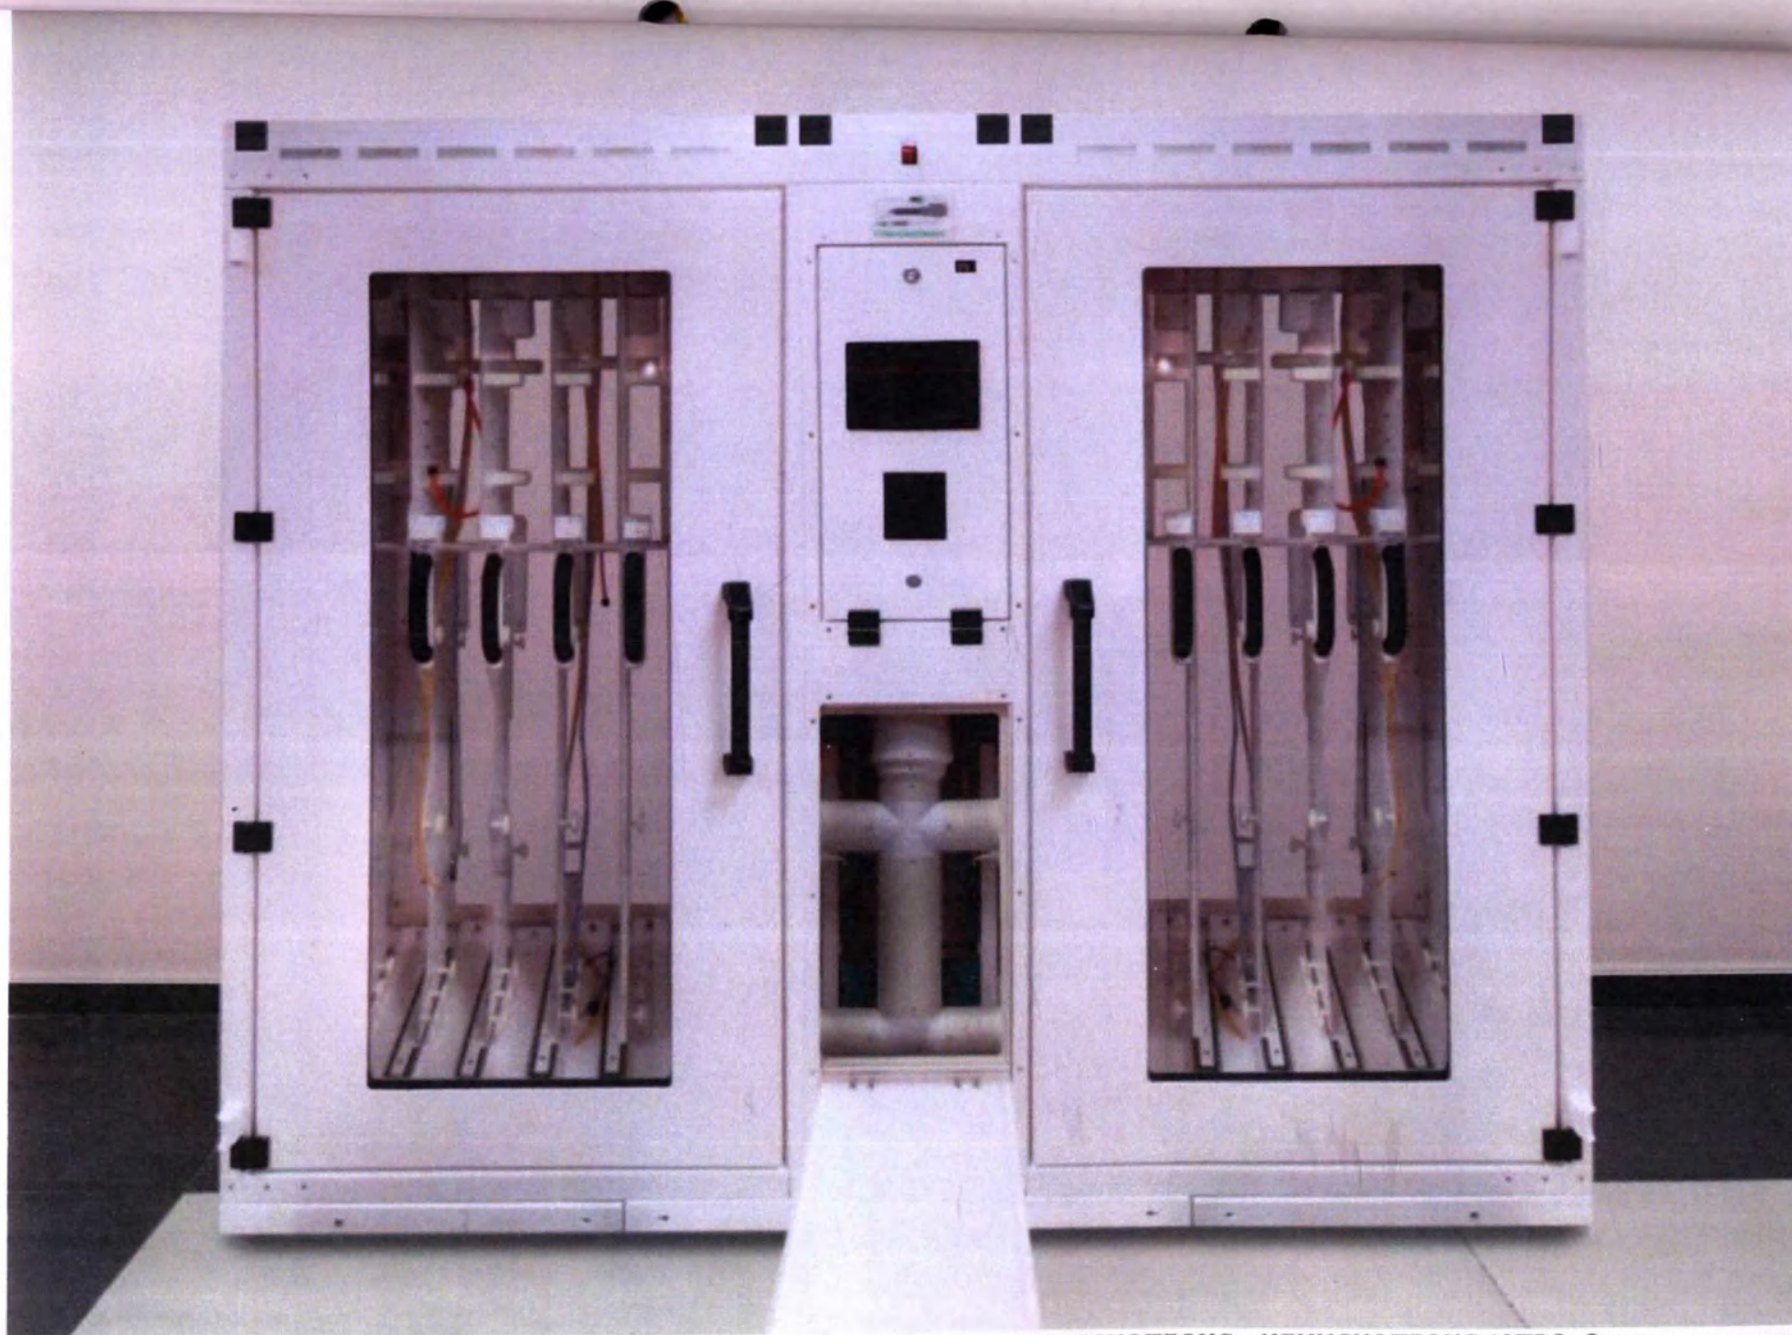

Фотографическое изображение №48. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыта дверь технического отсека с другой стороны.

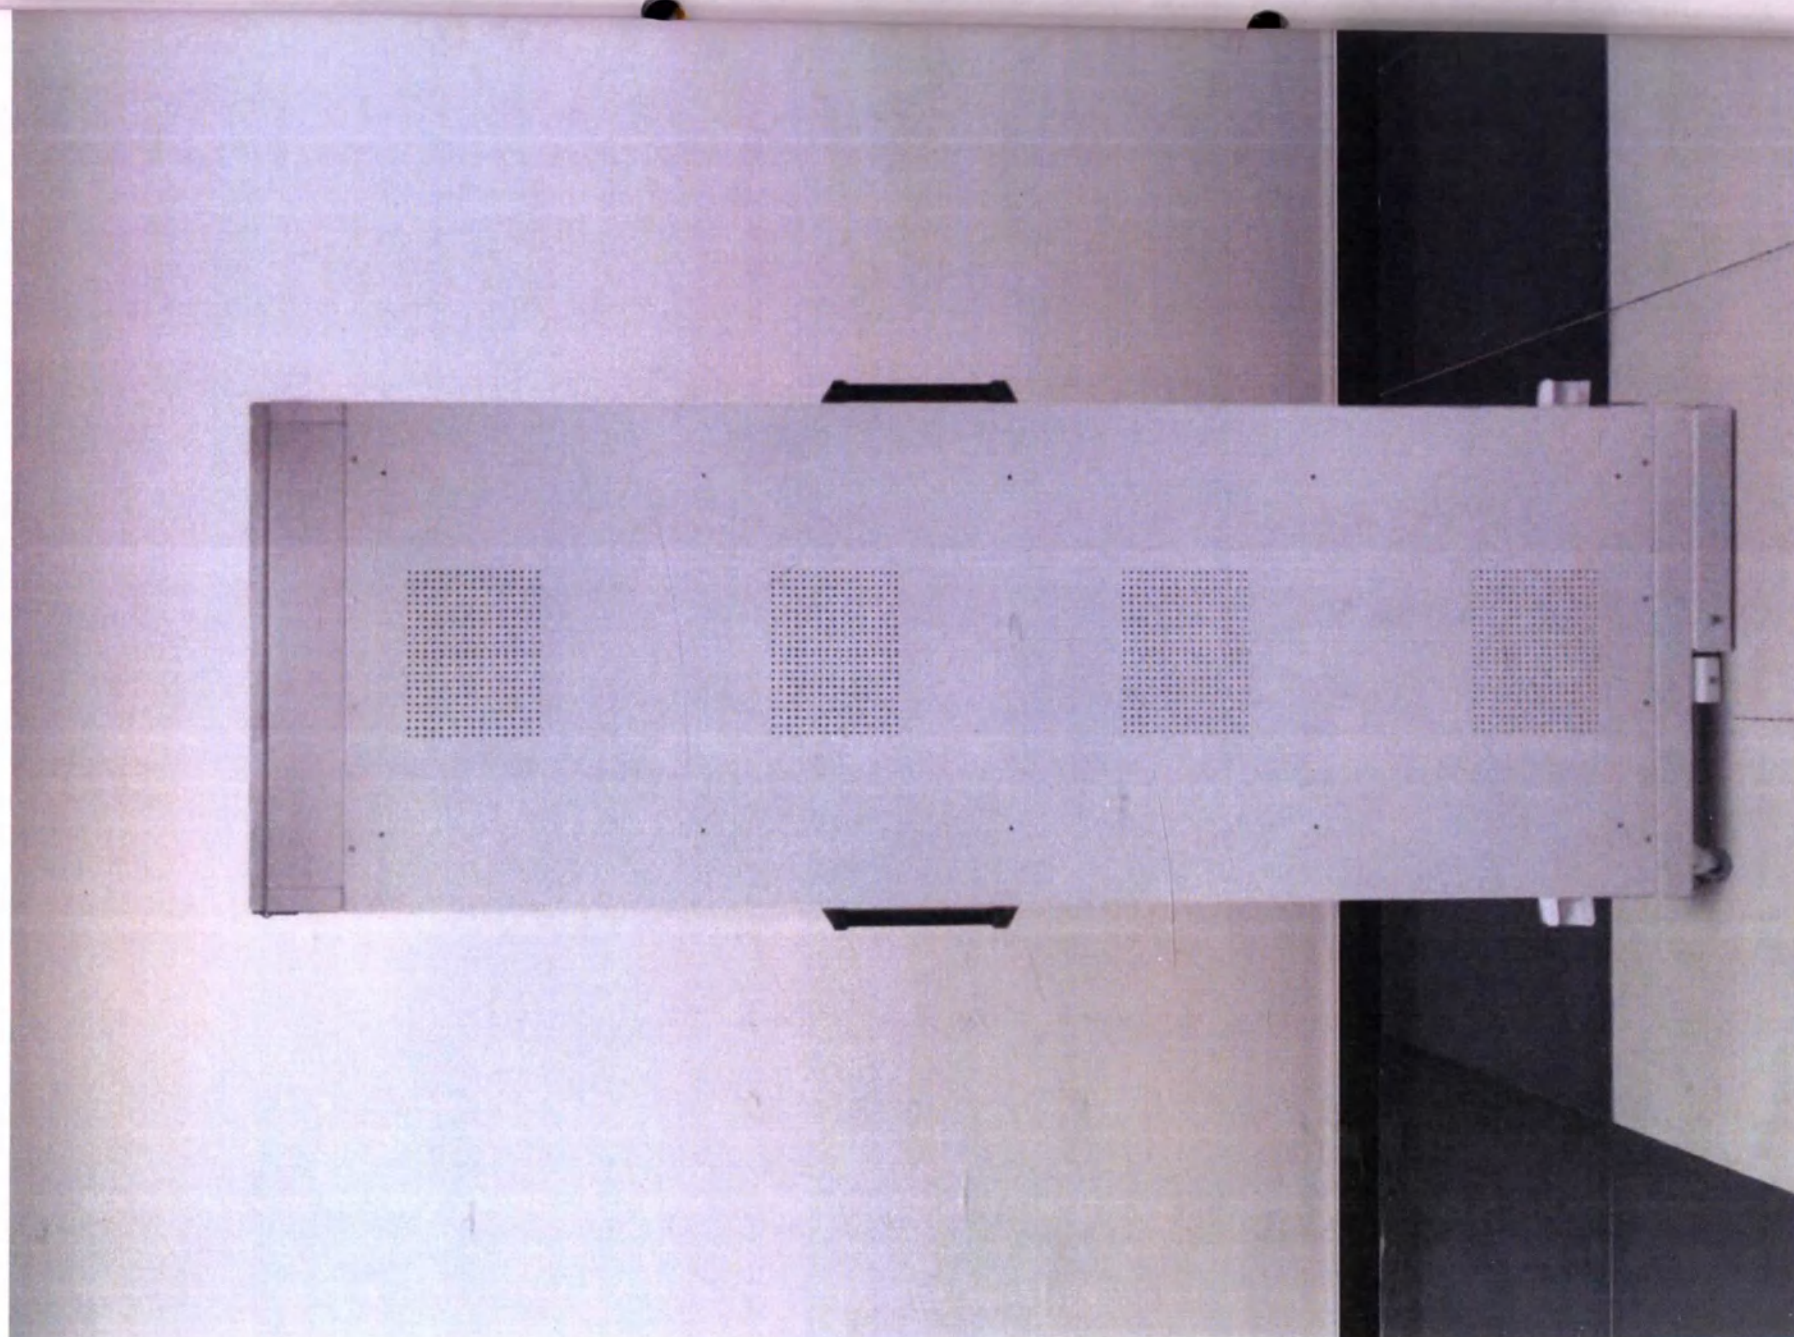

Фотографическое изображение №49. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Вид Шкафа с левого бока.

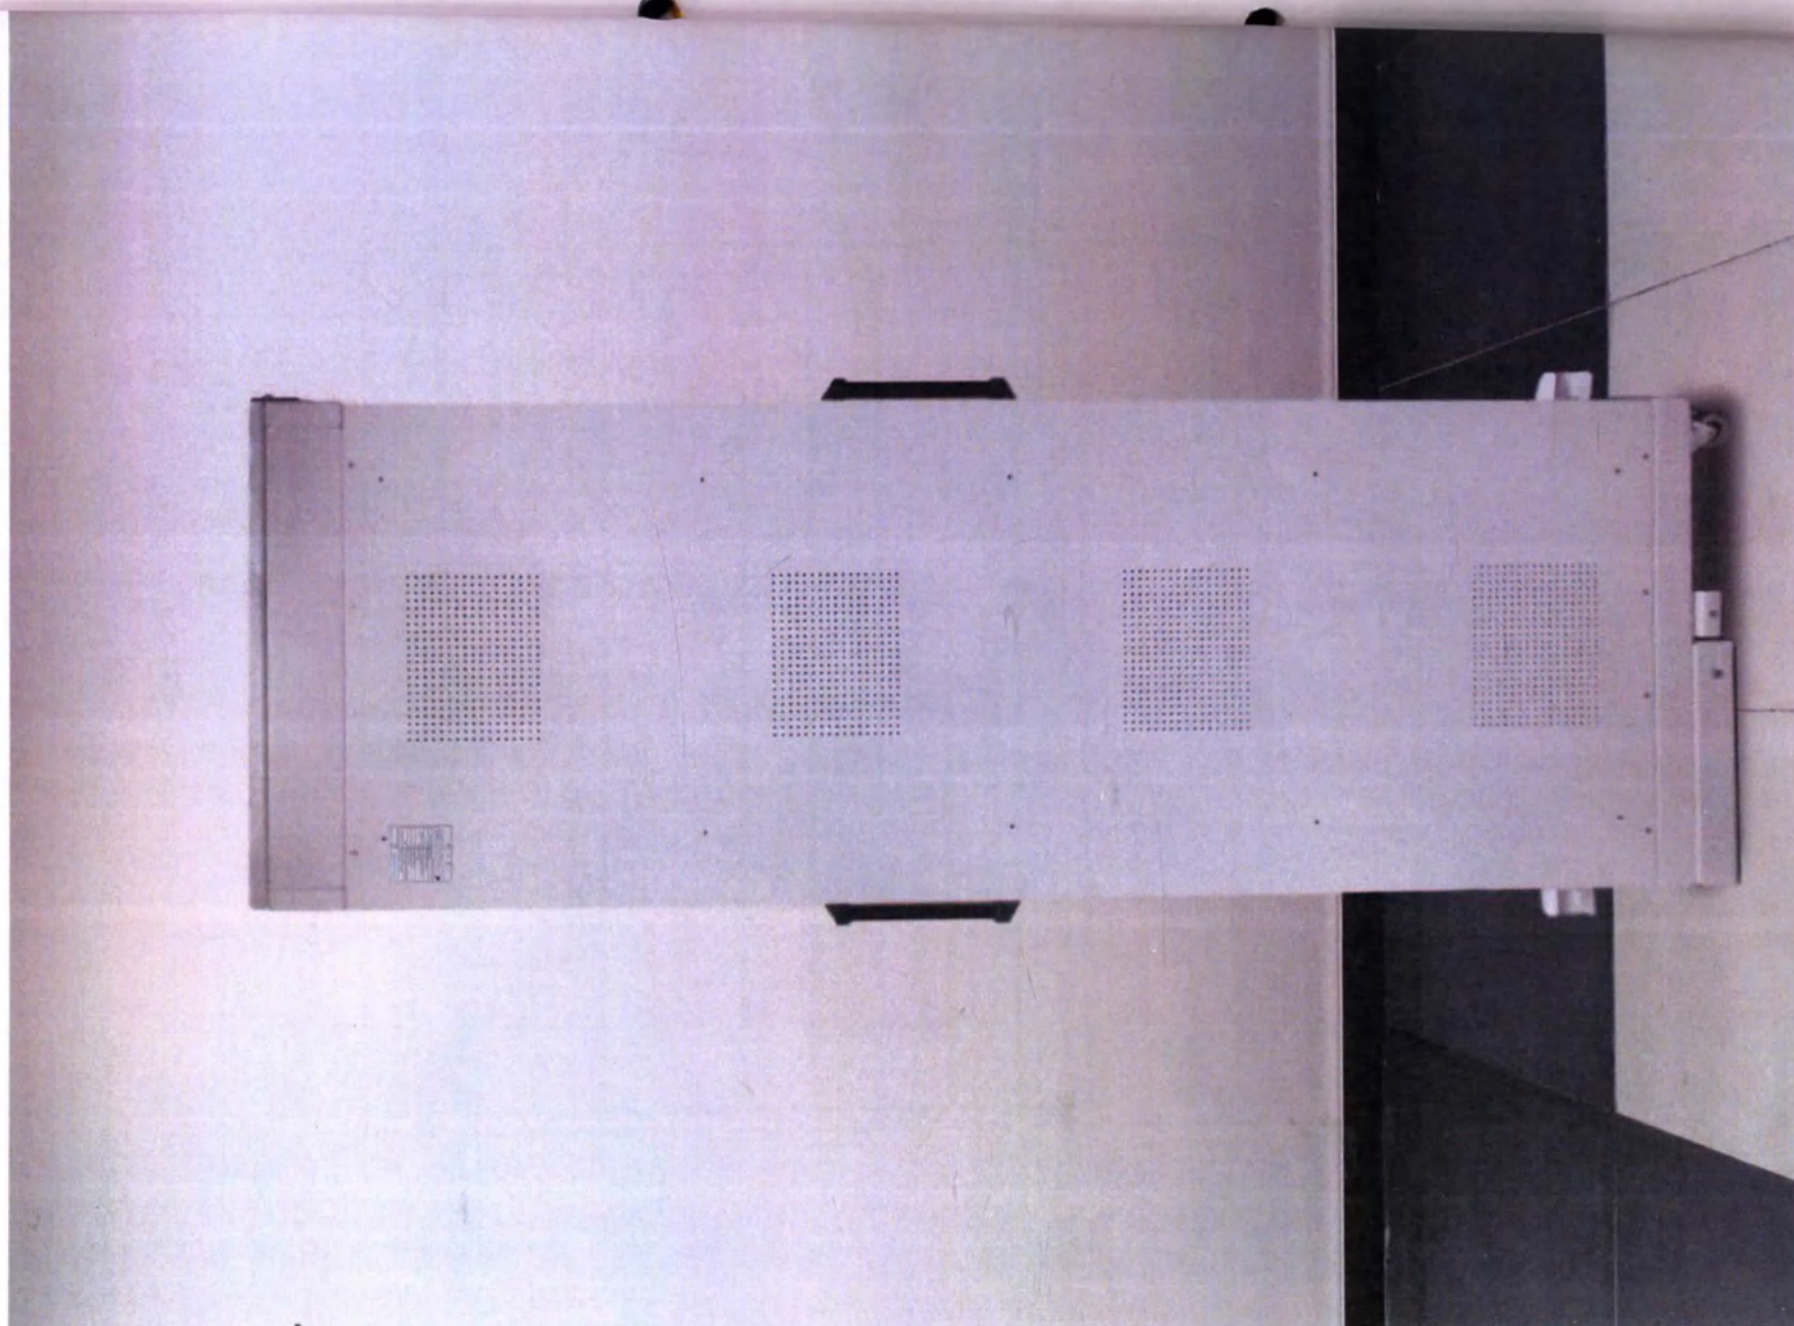

Фотографическое изображение №50. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Вид Шкафа с правого бока.

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов

КЛИНСКОПБОКС

00005

Объект: решение хранения гибких эндоскопов в асептической среде

Вариант исполнения	КЛИНСКОПБОКС-12ПРО
Напряжение, В/Частота, Гц	~230/50
Мощность, Вт	425
Степень защиты	IP10
Масса, кг	400
Габариты (ШхГхВ), мм	2250х810х1958,50
Дата изготовления	07.2023г.
Сборщик	Санталин Р.З.

ТУ 12.50.50-201-42718084-2023


Производитель: ООО "ЦРМИ", Россия, 111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная д.2, стр.6, пом. 20. Тел.: +7(991)591-77-97, эл. почта: ebg.msk@yandex.ru

Место производства: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Монтажная д.8


Условия эксплуатации при температуре от +10 до +40 °С, влажность до 80%

Использование изделия утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

от " " 20 год




Фотографическое изображение №51. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Маркировка Шкафа.

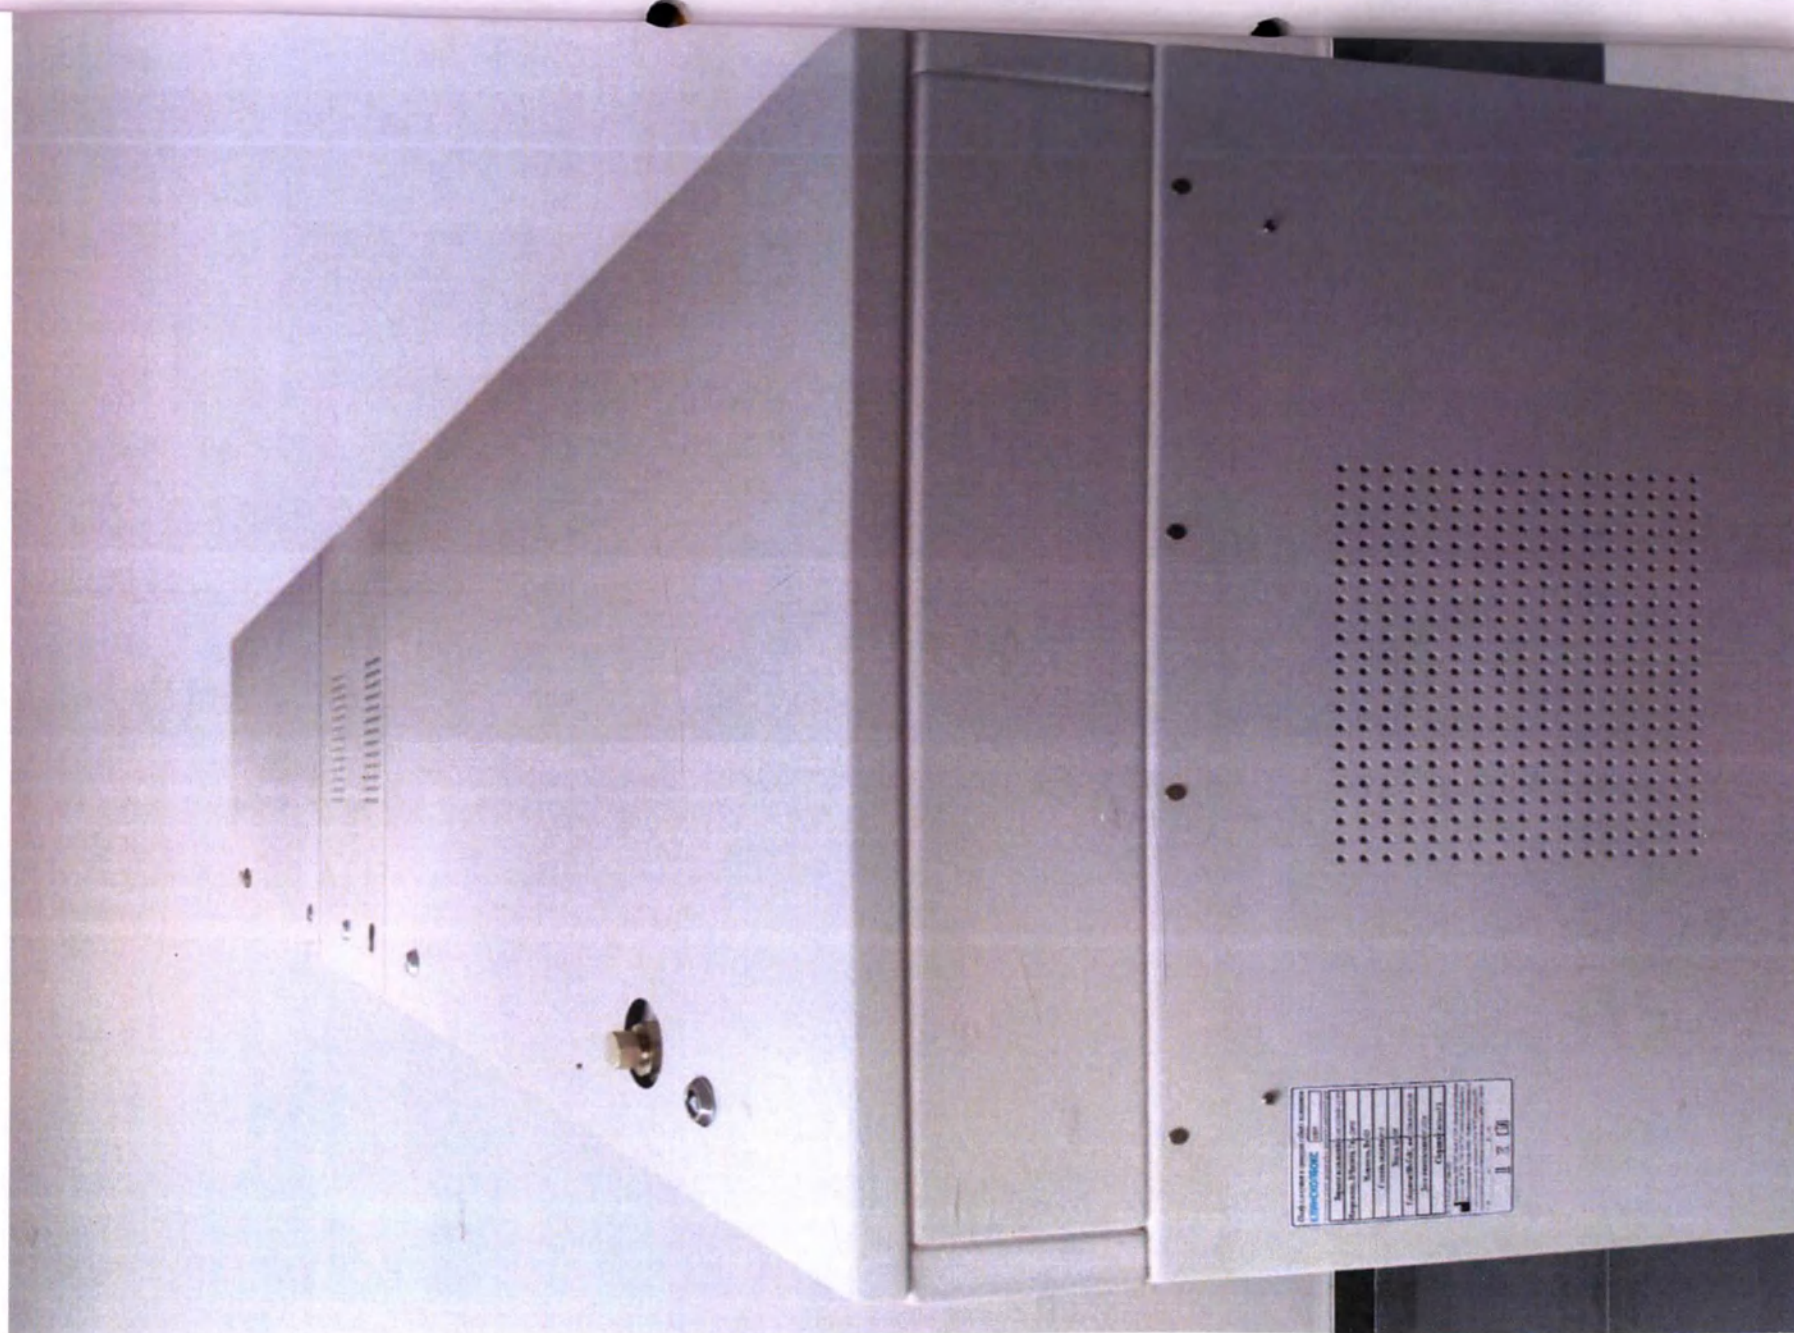


Фотографическое изображение №52. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Верхняя крышка технического отсека.




Фотографическое изображение №53. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС», КЛИНСКОПБОКС-12ПРО. Открыта верхняя крышка технического отсека.

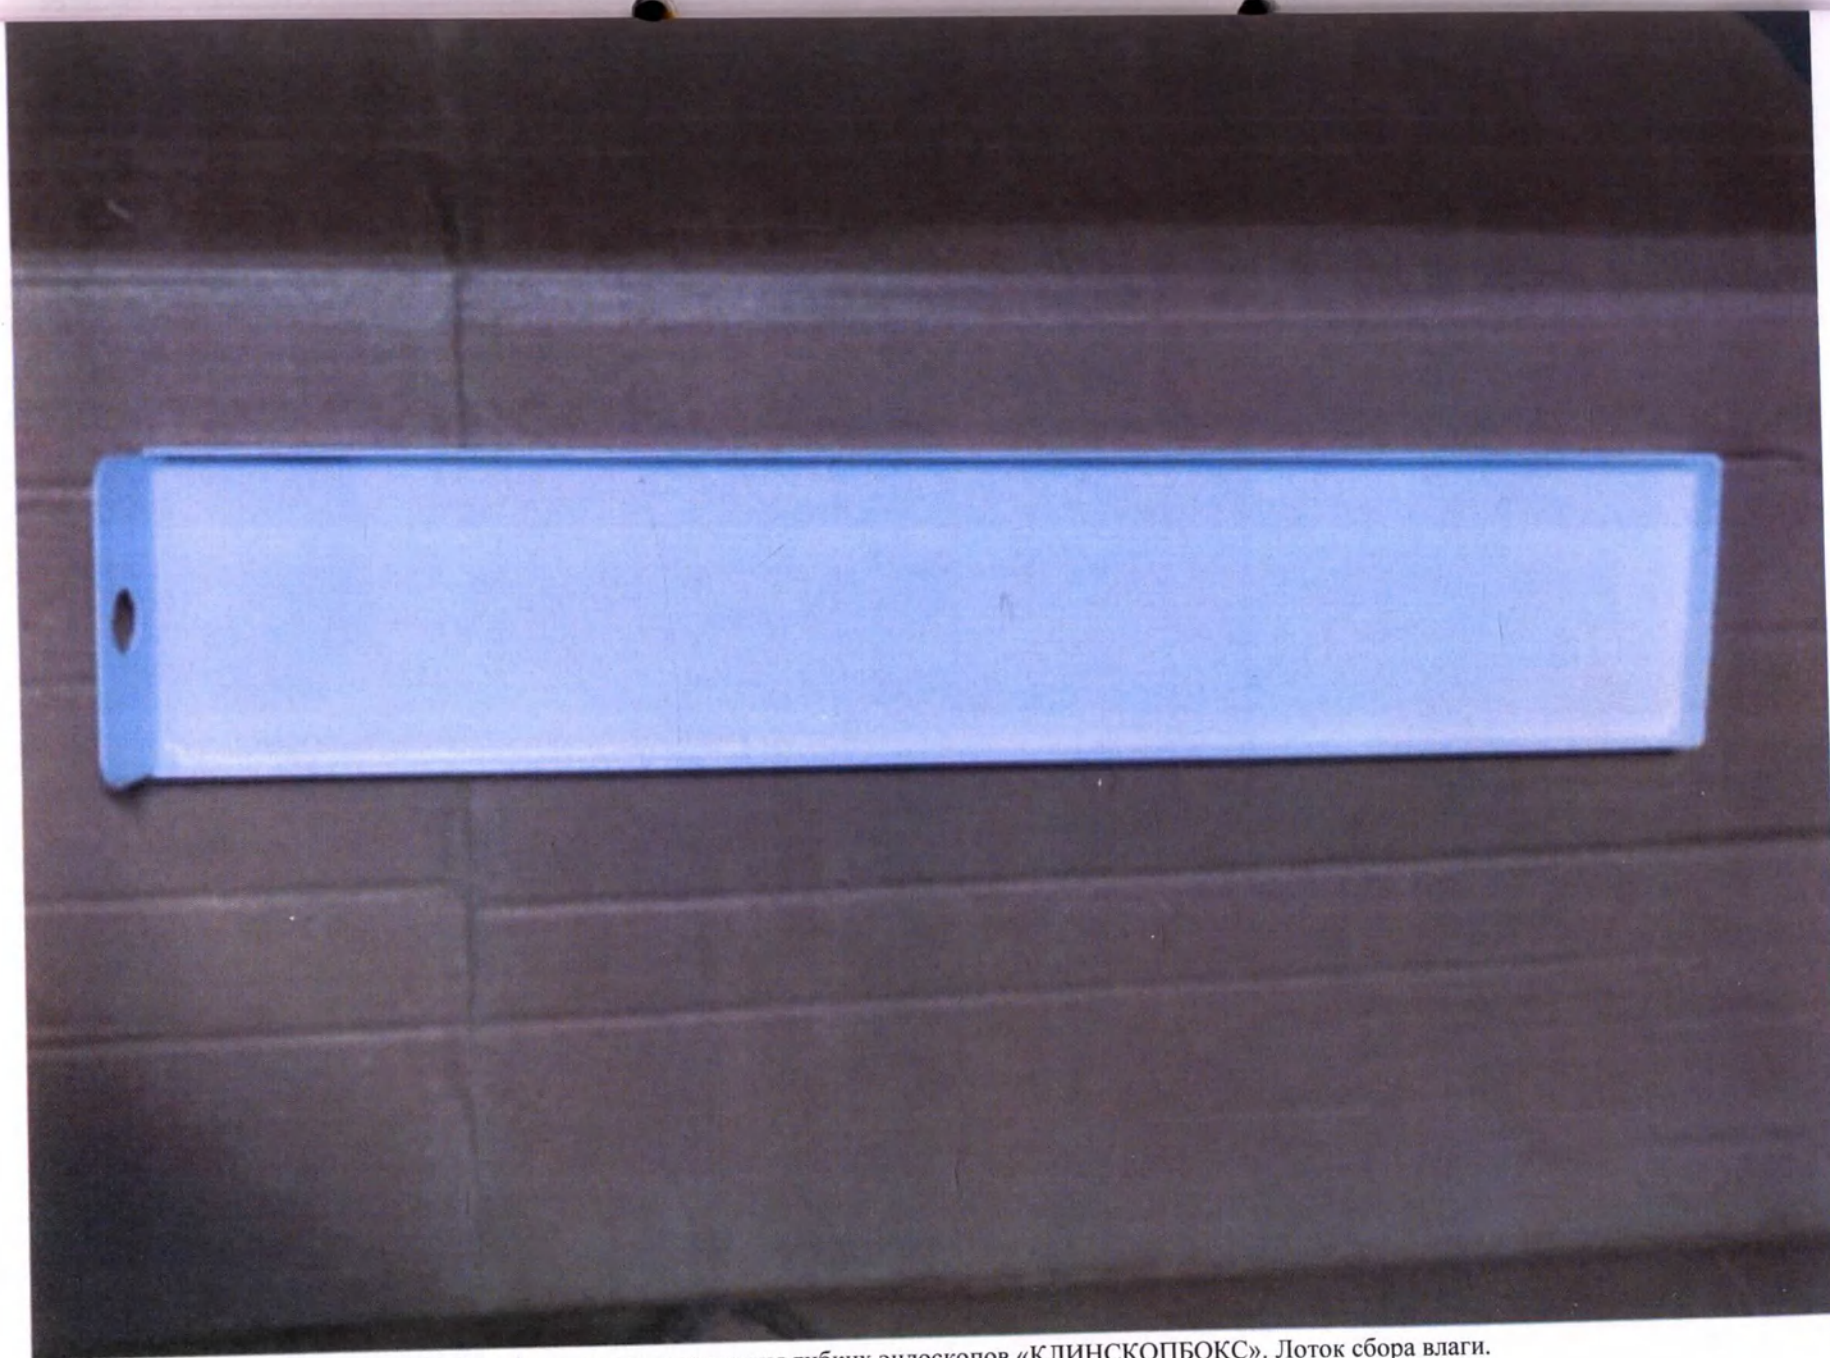


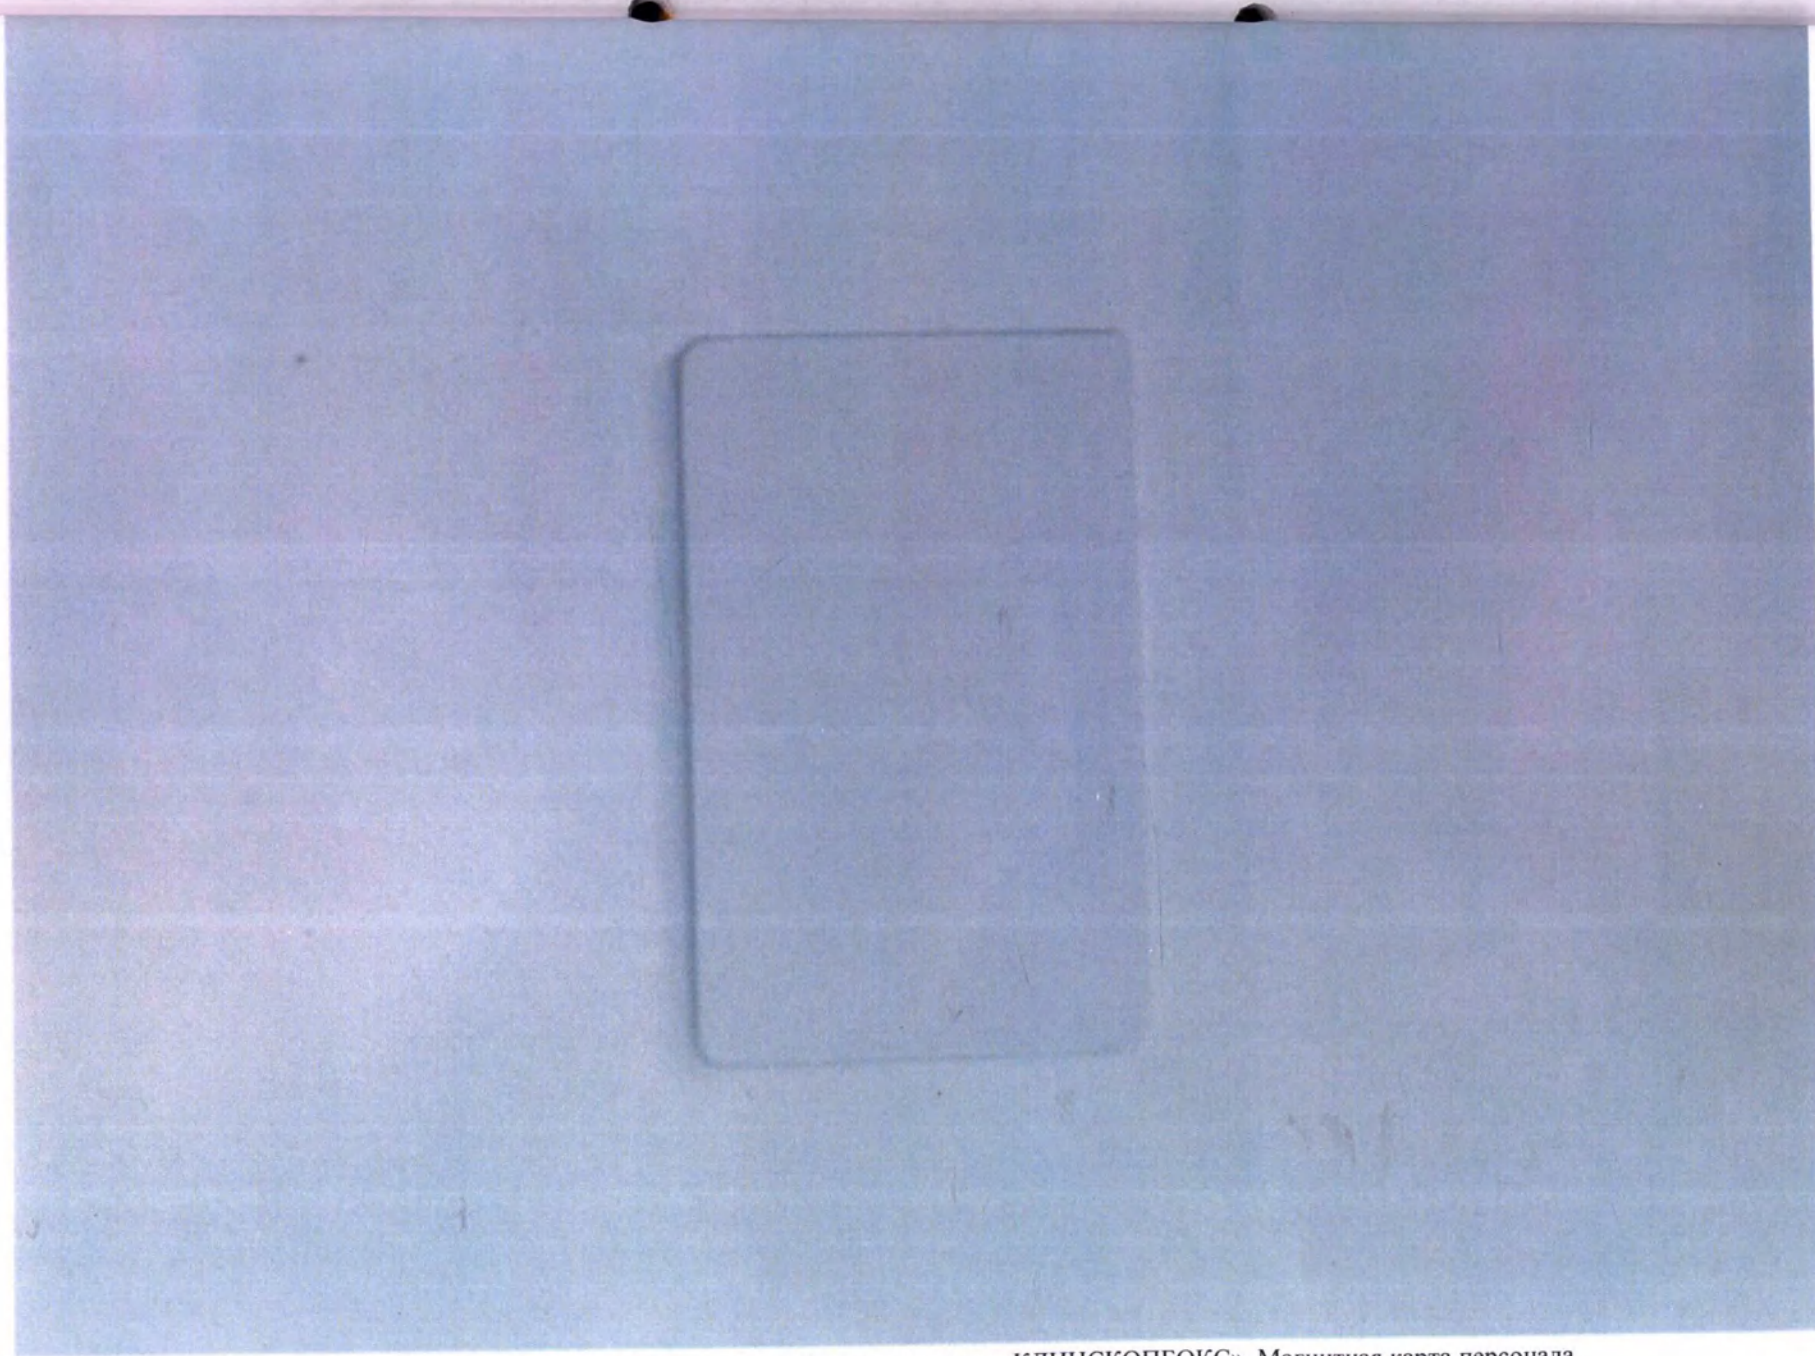


Фотографическое изображение №55. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Магнитная карта персонала.

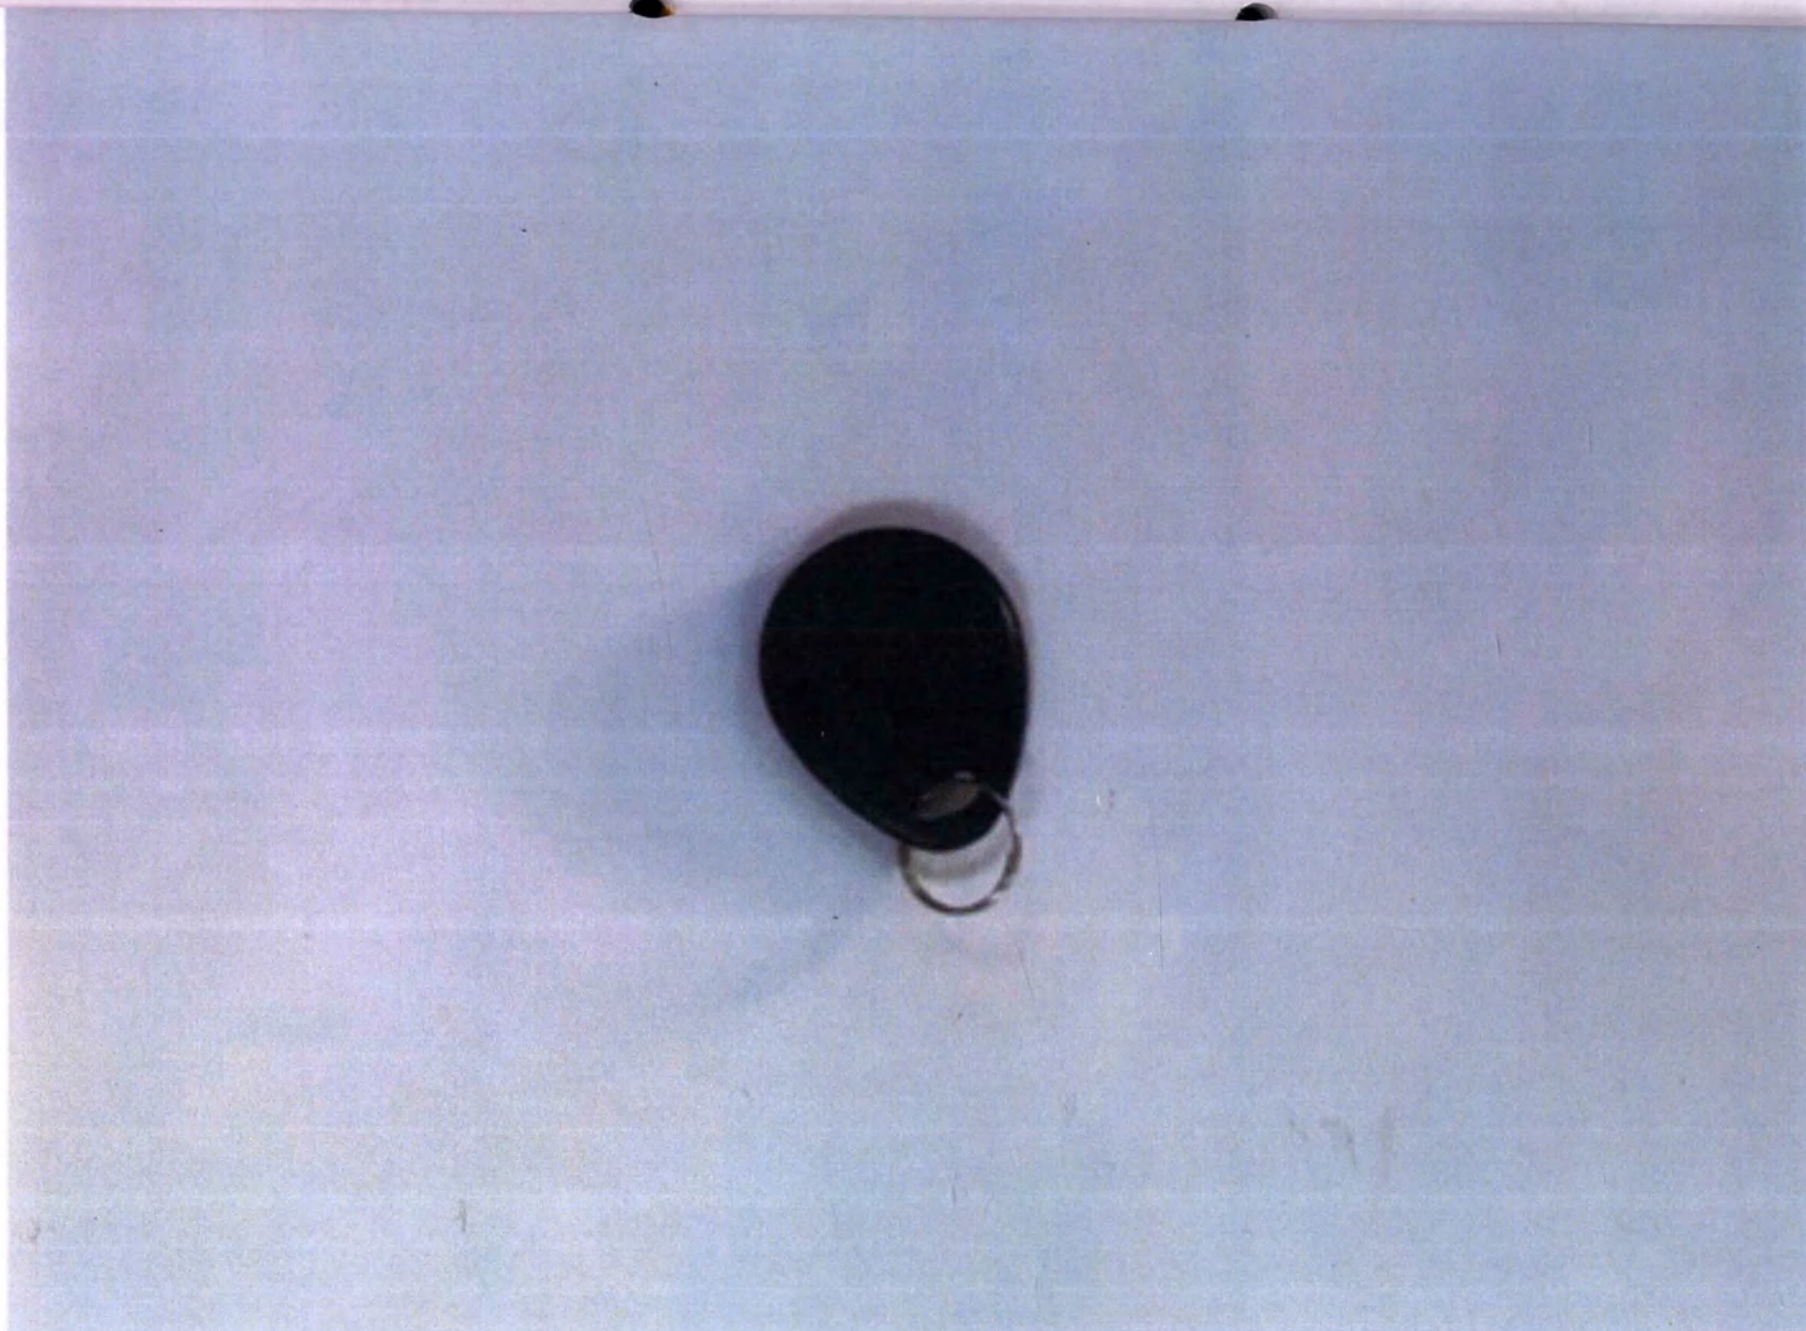

Фотографическое изображение №56. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Метка для эндоскопов.

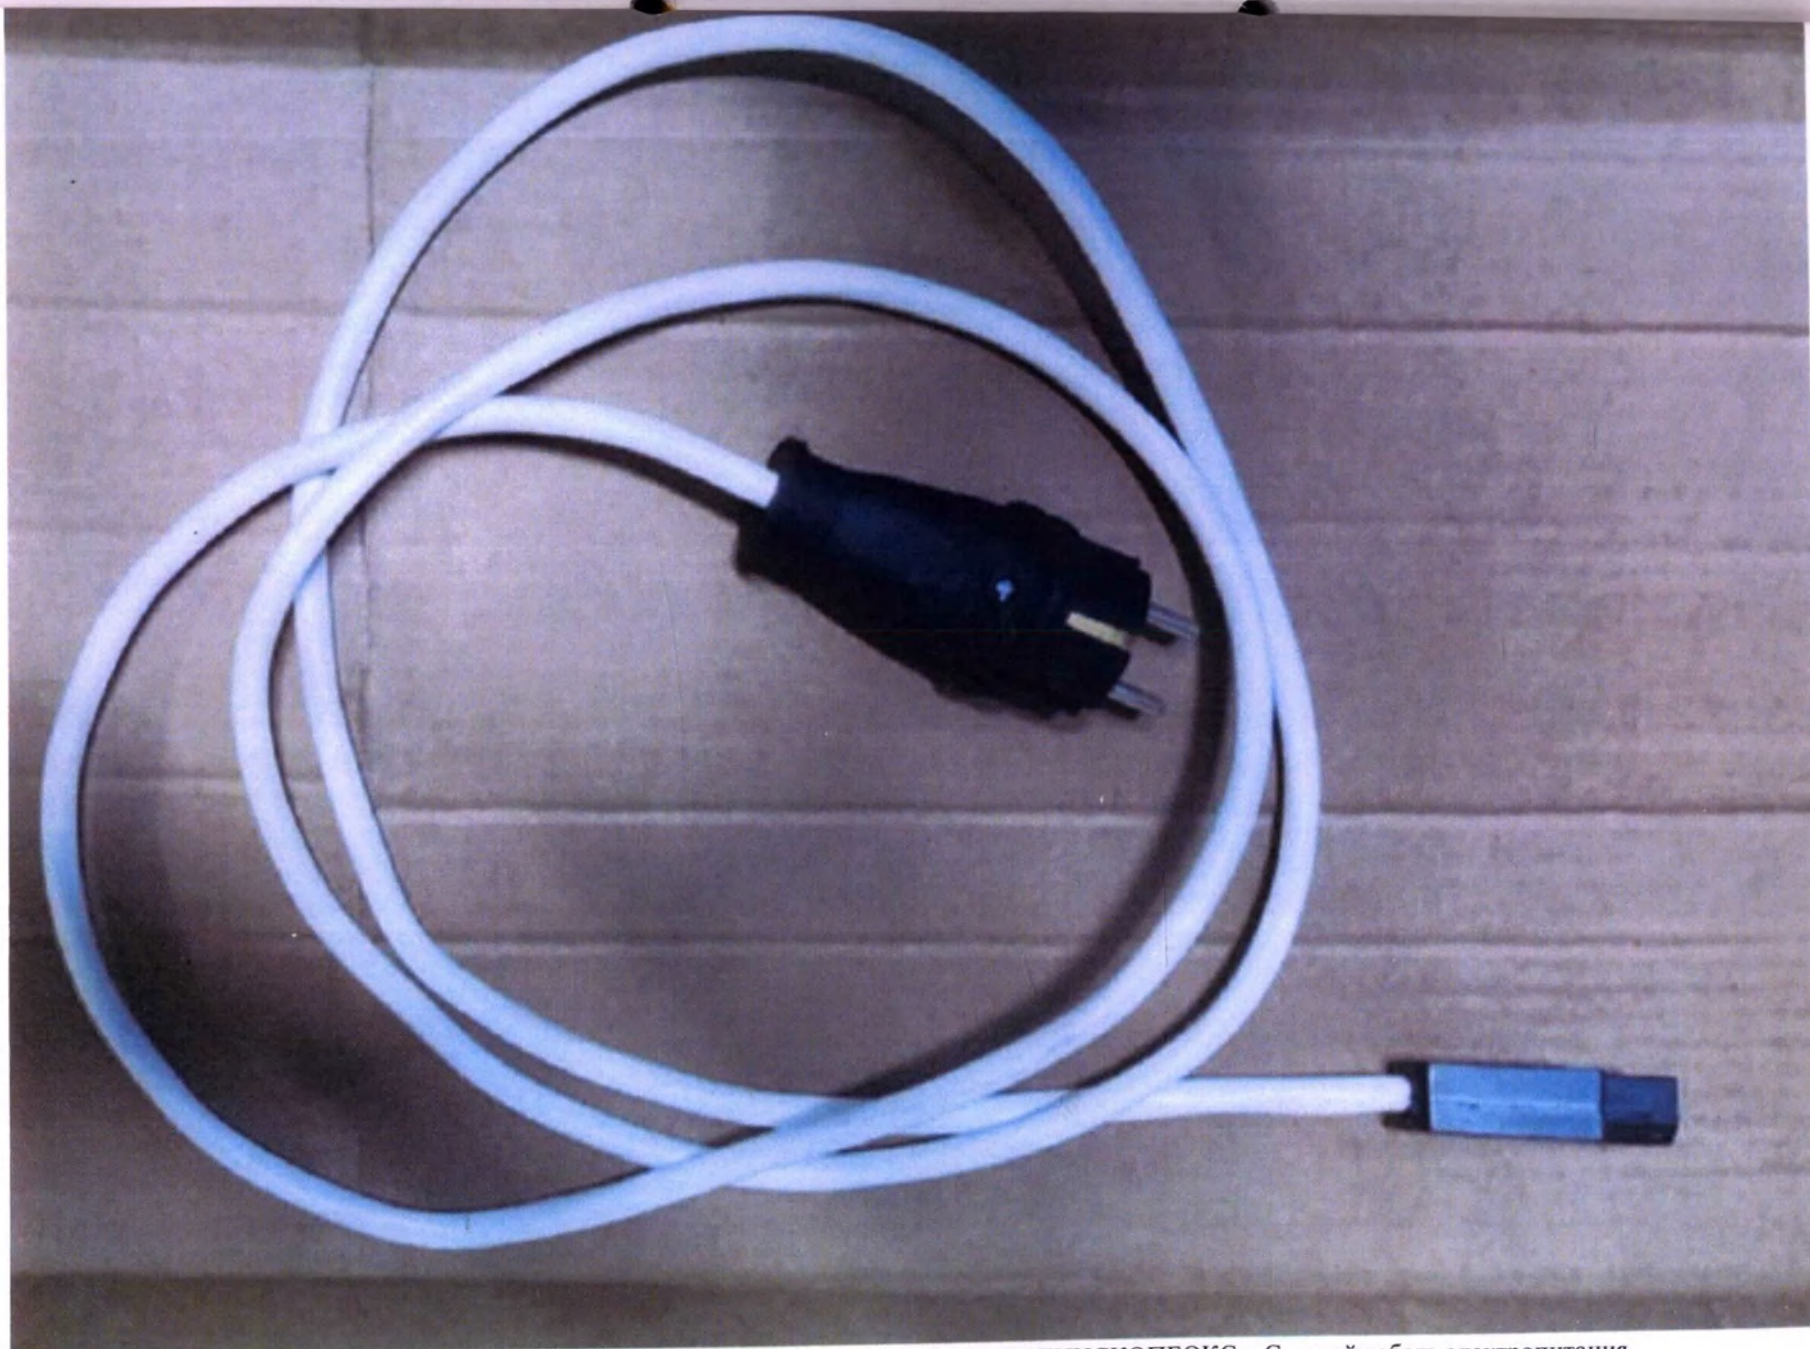


Фотографическое изображение №57. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Сетевой кабель электропитания.

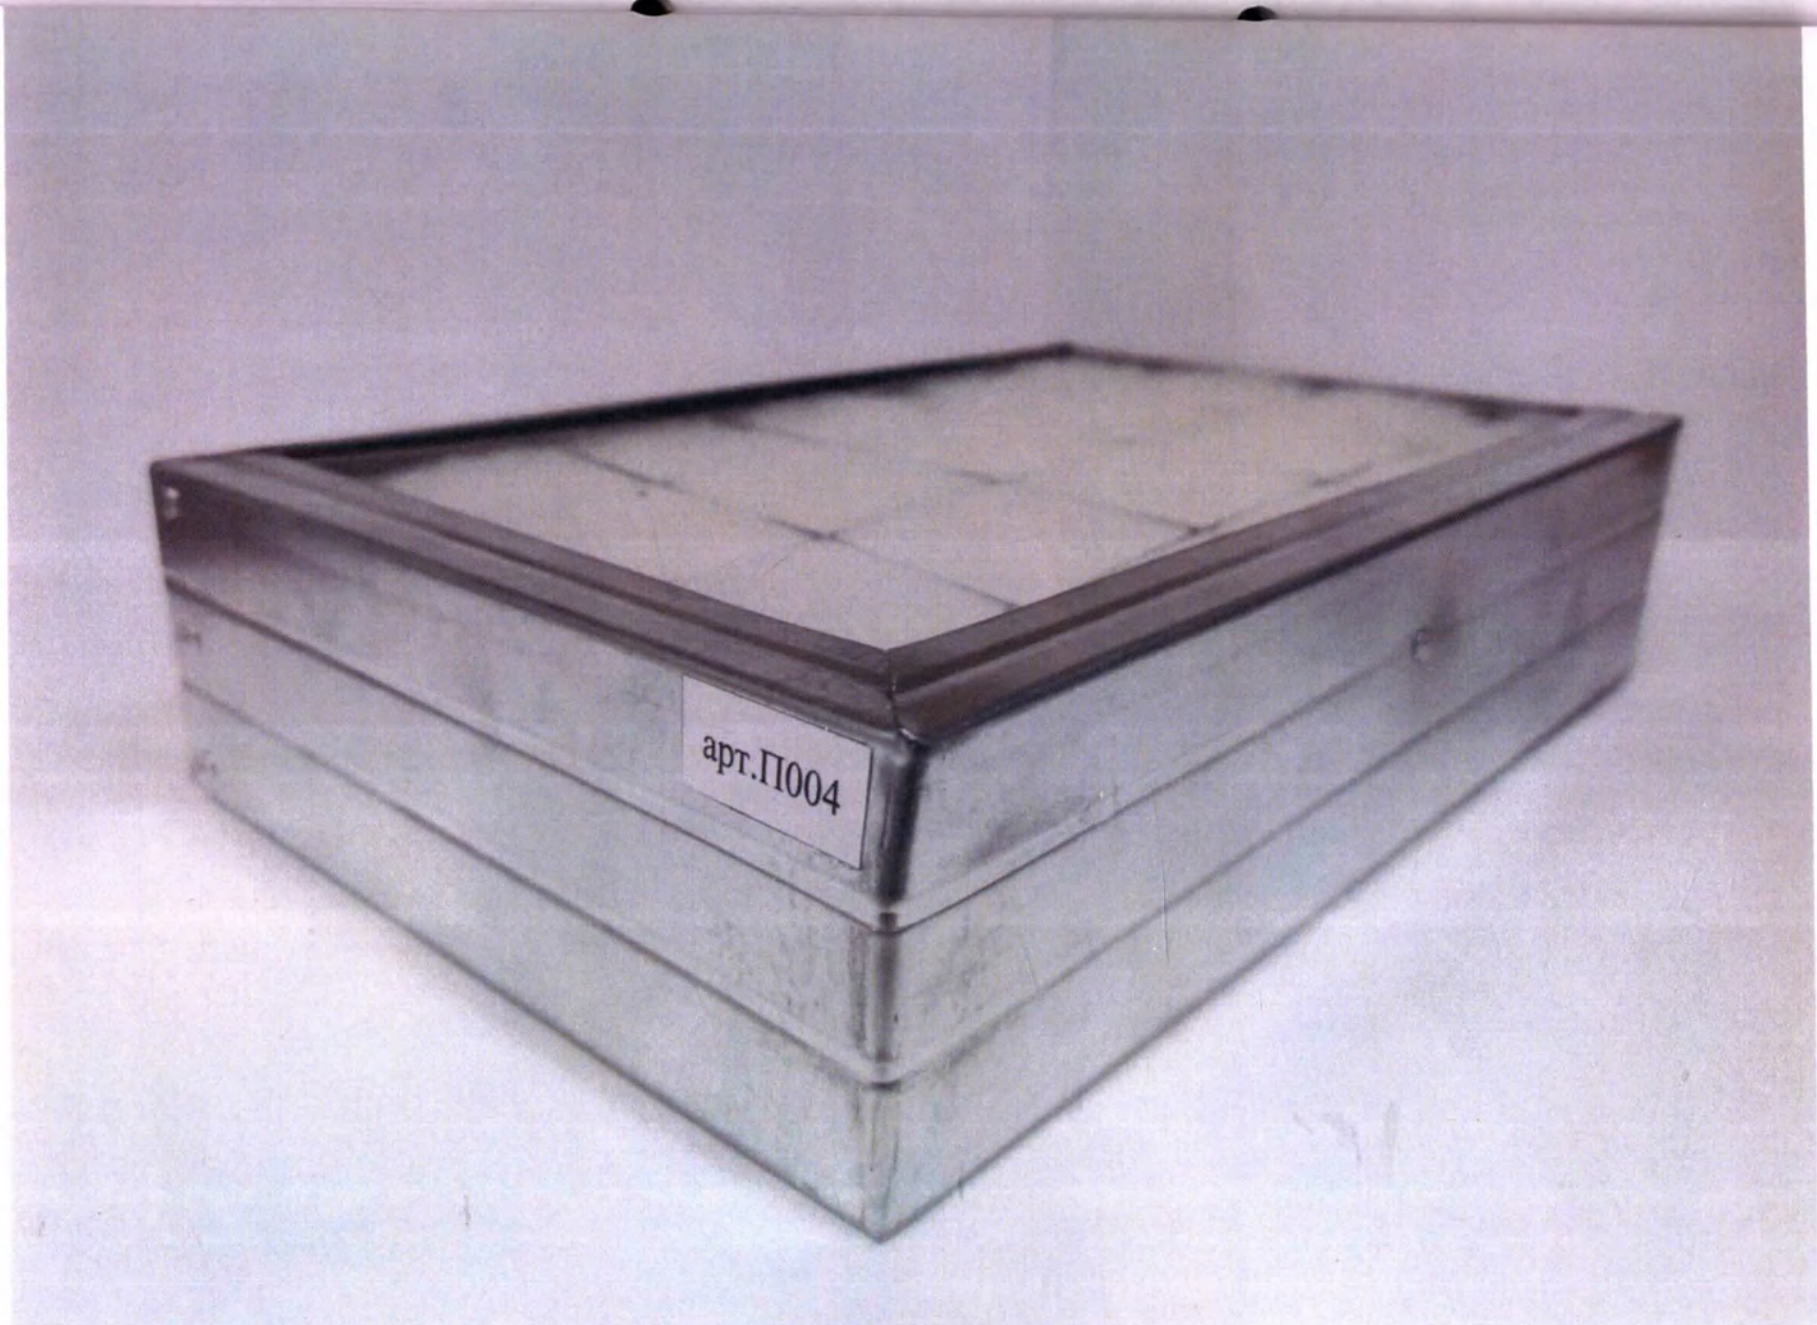


Фотографическое изображение №58. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Фильтр отсека воздушный G4.

Фотографическое изображение №59. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Фильтр отсека воздушный Н14.



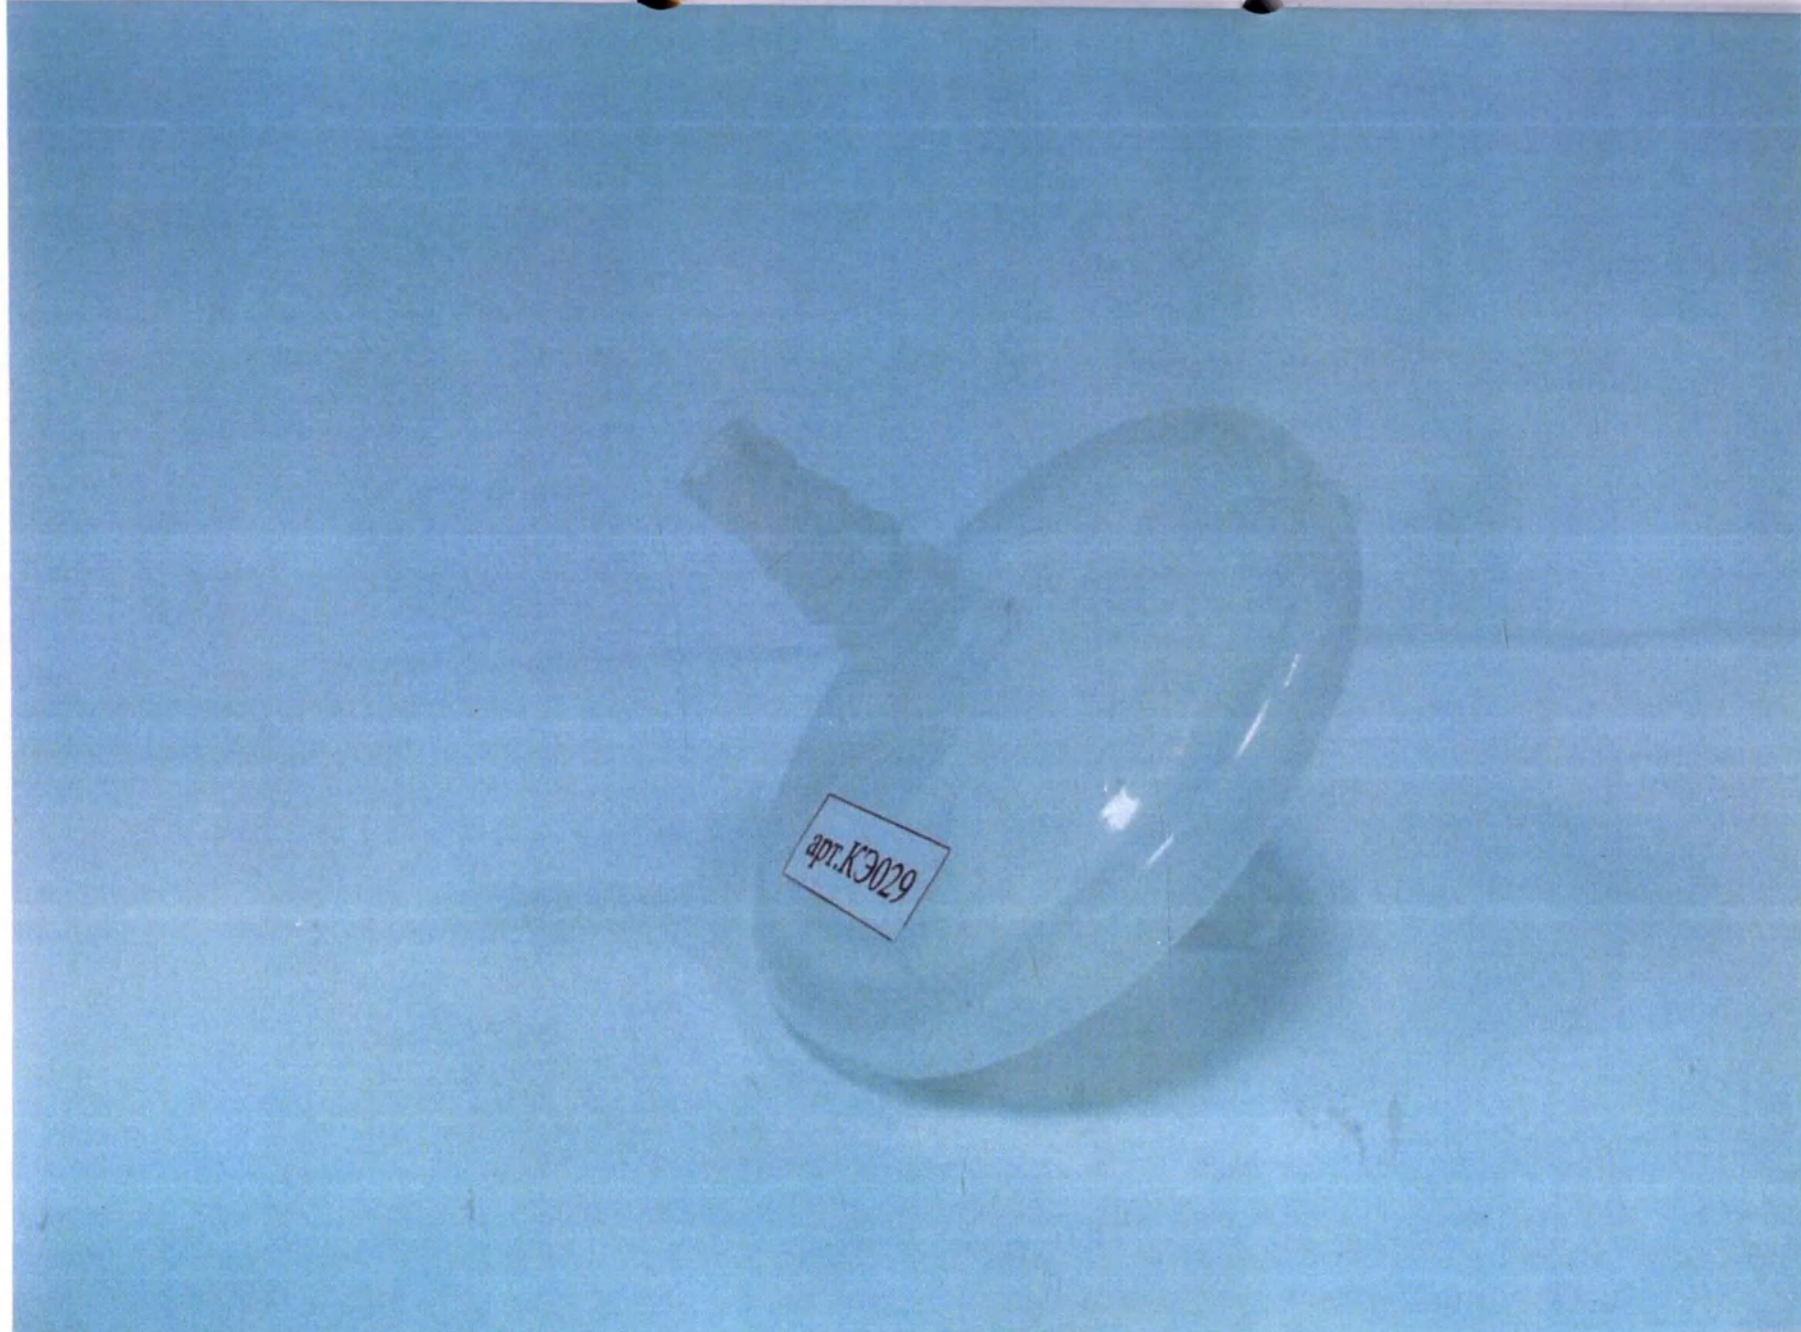

Фотографическое изображение №60. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Фильтр воздушный для каналов эндоскопов 0,2 мкм.

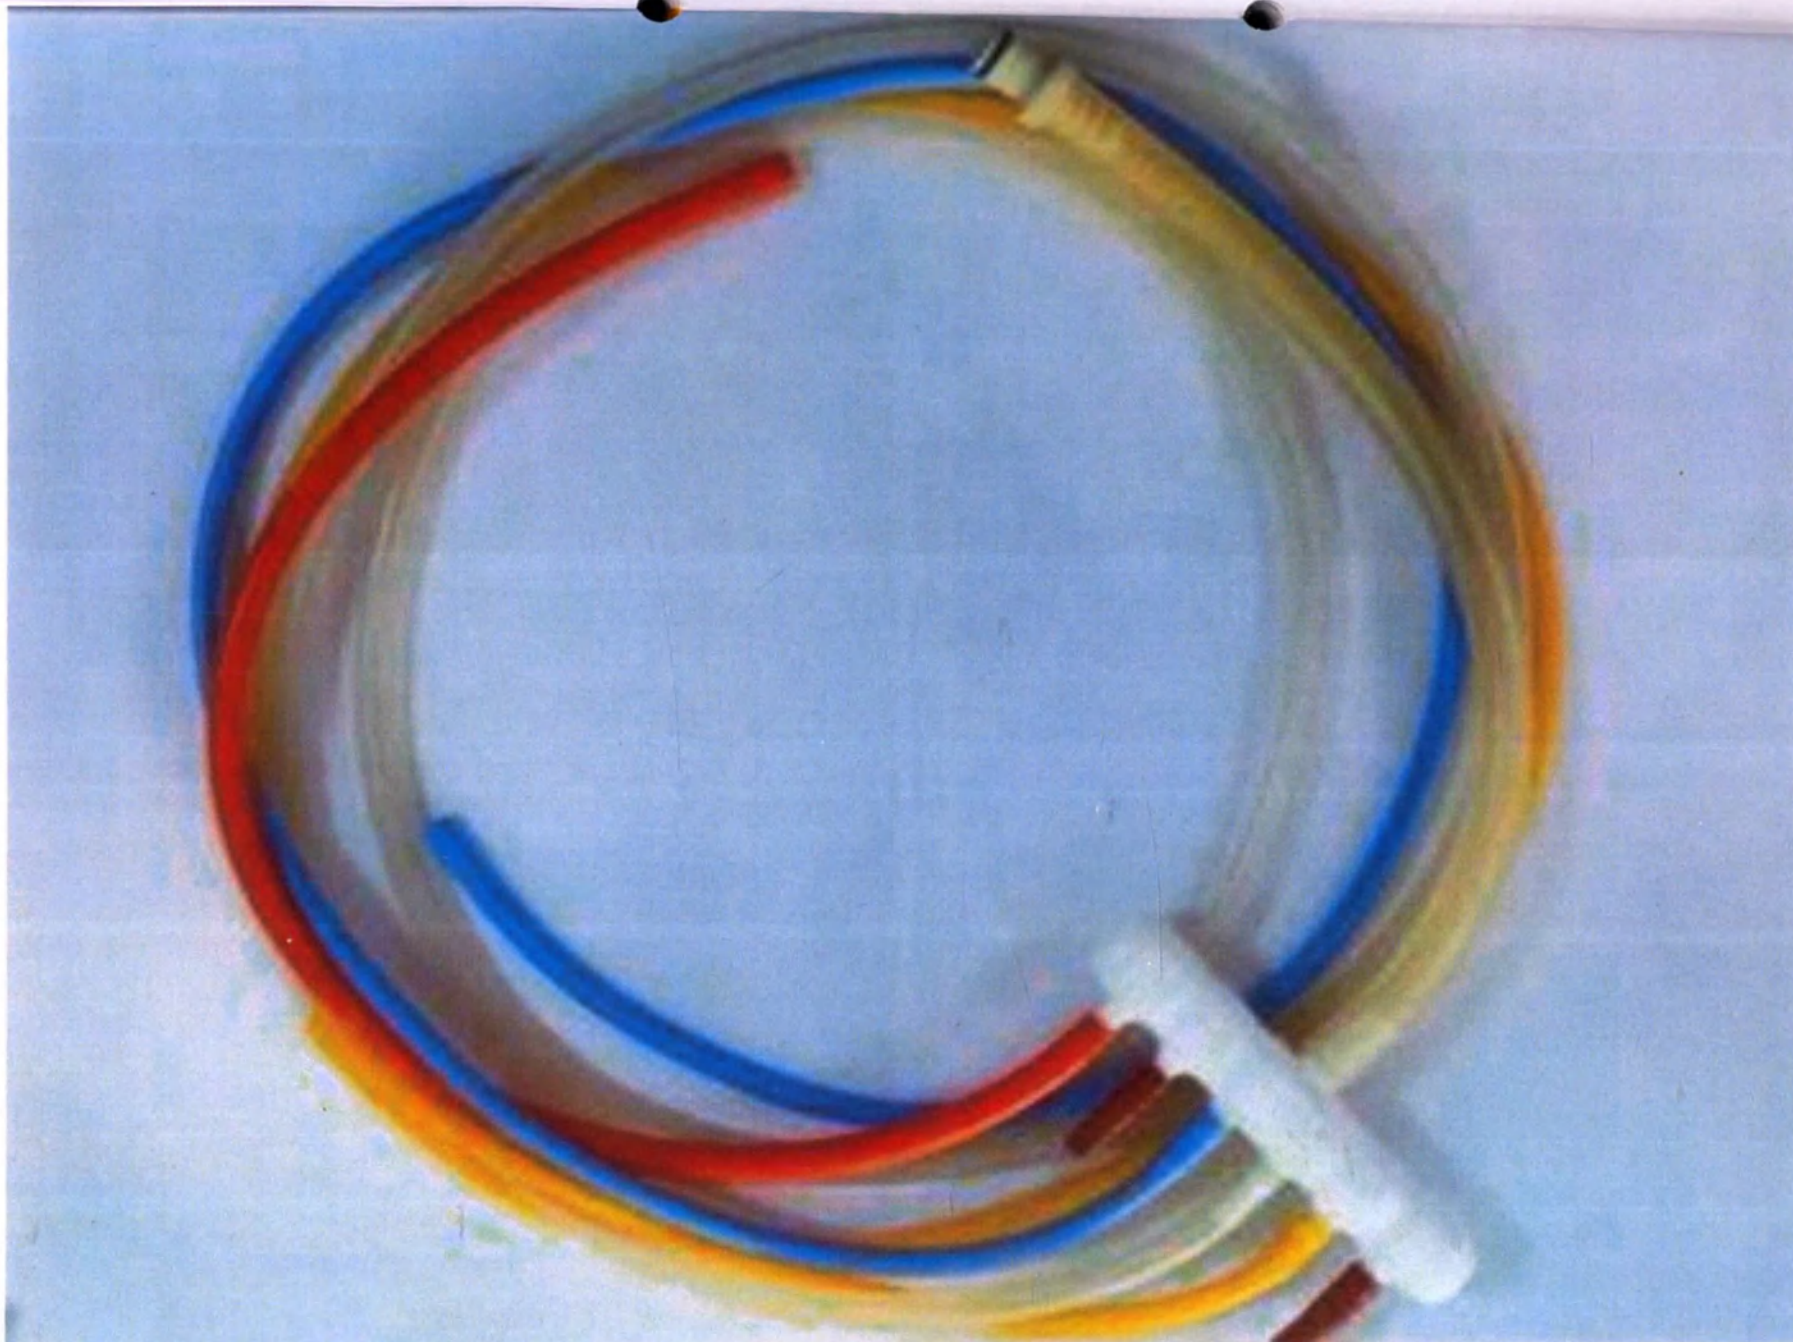

Фотографическое изображение №61. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Адаптер для подключения эндоскопа.



Фотографическое изображение №62. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов «КЛИНСКОПБОКС». Переходники для подключения каналов эндоскопа.

Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов

КЛИНСКОПБОКС

Эффективное решение хранения гибких эндоскопов в асептической среде

Вариант исполнения	
Упаковано	
Производитель	

Условия транспортирования при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности до 100%.
Хранение при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности до 98%, в упаковке - 2 года.



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

64/1111111111 листов

Генеральный директор ООО «ЦБГ»

Коржова Д.Ю. Корж

