



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

лоток для анализатора «AutoBlot 3000» на 20 ячеек (артикул А-1-0101)

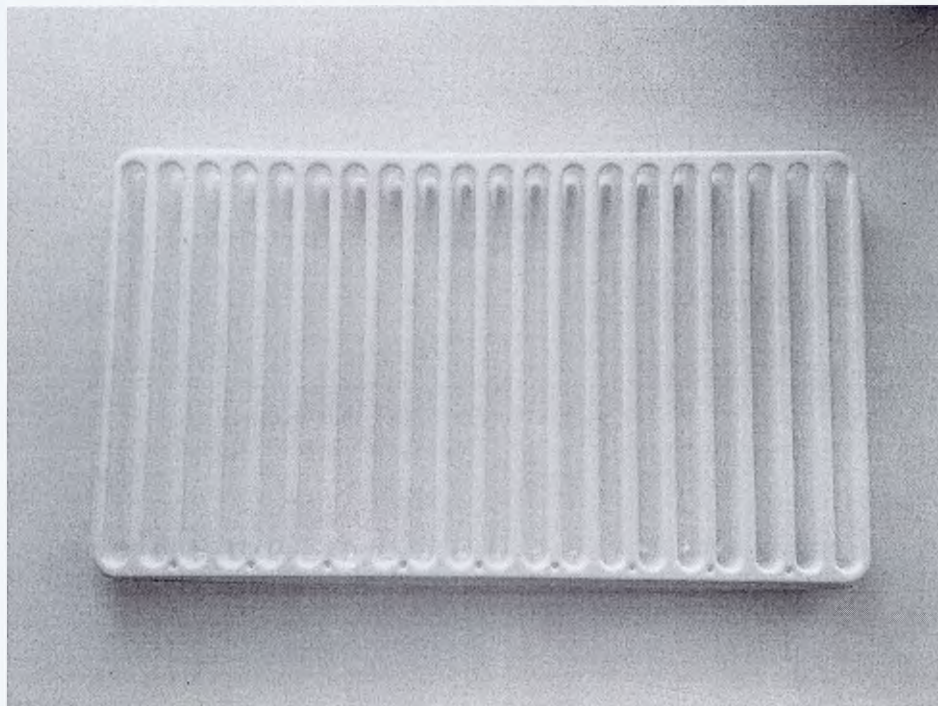


лоток для анализатора «ProfiBlot 48» на 48 ячеек (артикул А-1-0100)

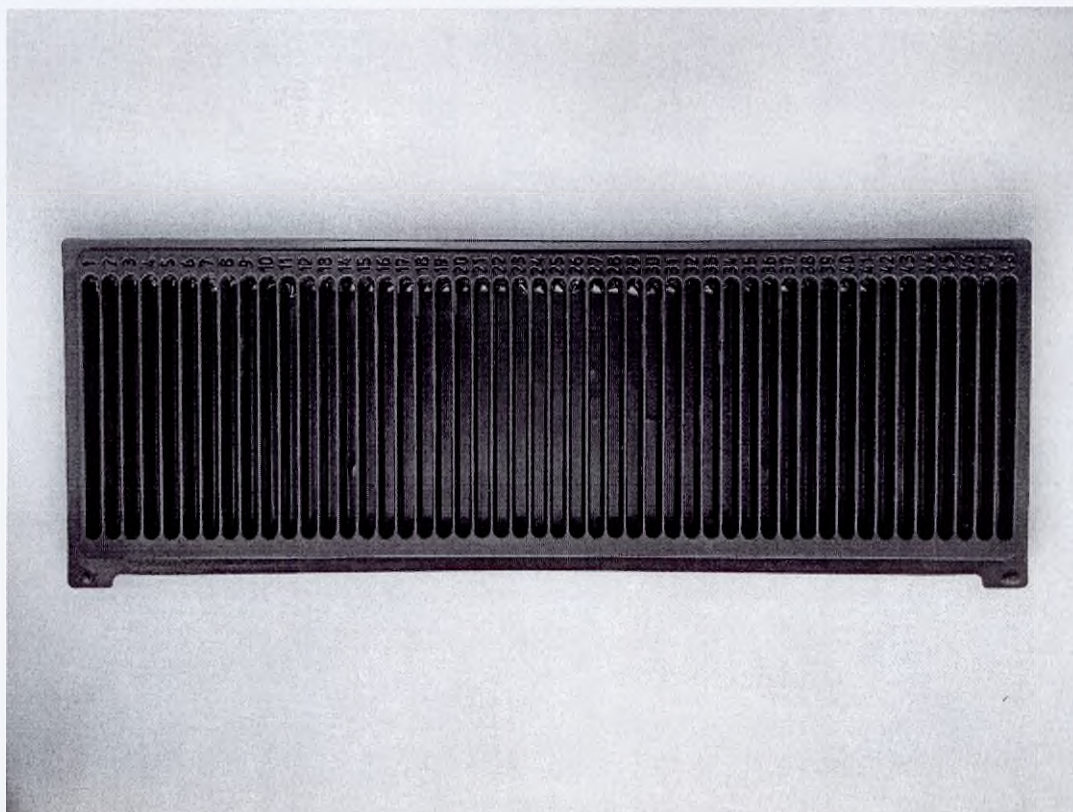


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


лоток для анализатора «AutoBlot 3000» на 20 ячеек (артикул А-1-0101)

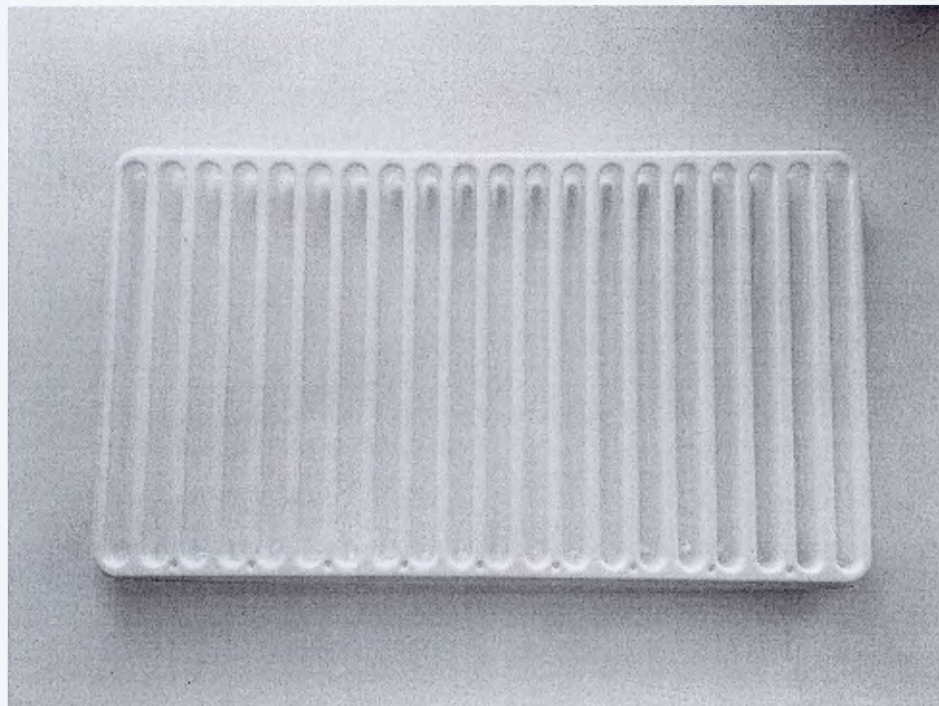


лоток для анализатора «ProfiBlot 48» на 48 ячеек (артикул А-1-0100)

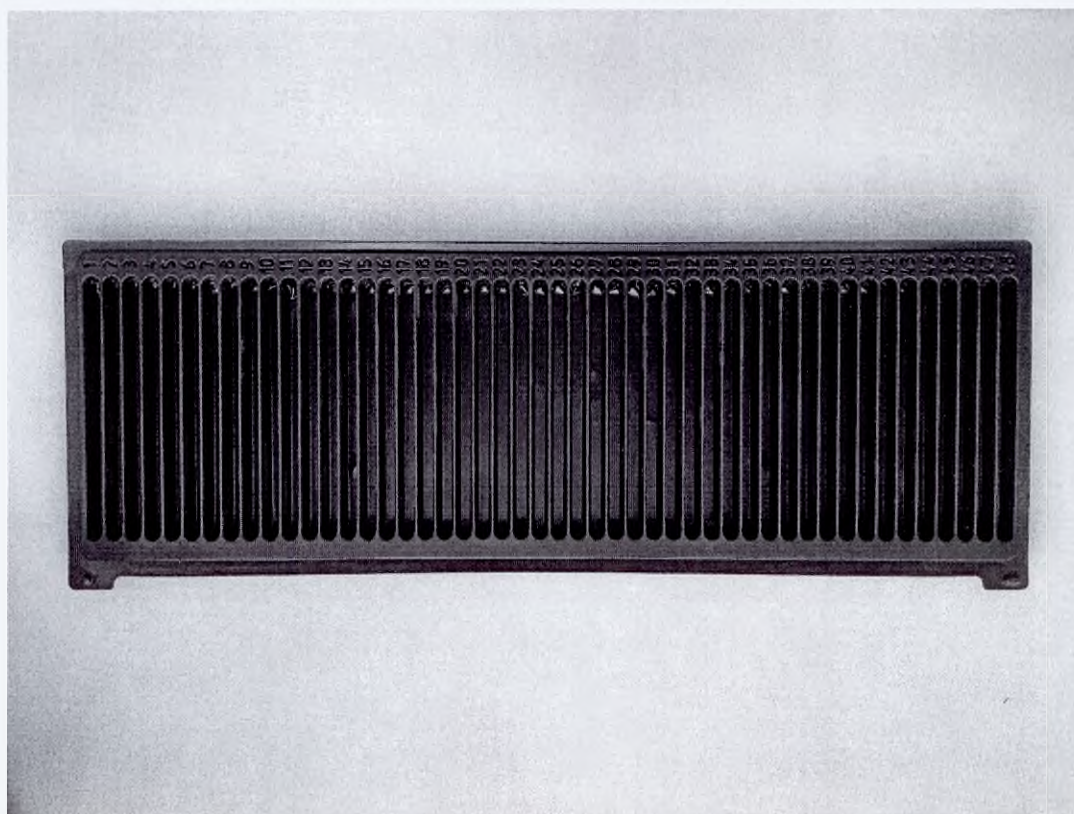

лоток для анализатора «ErbaBlot» на 48 ячеек (артикул А-1-0102)

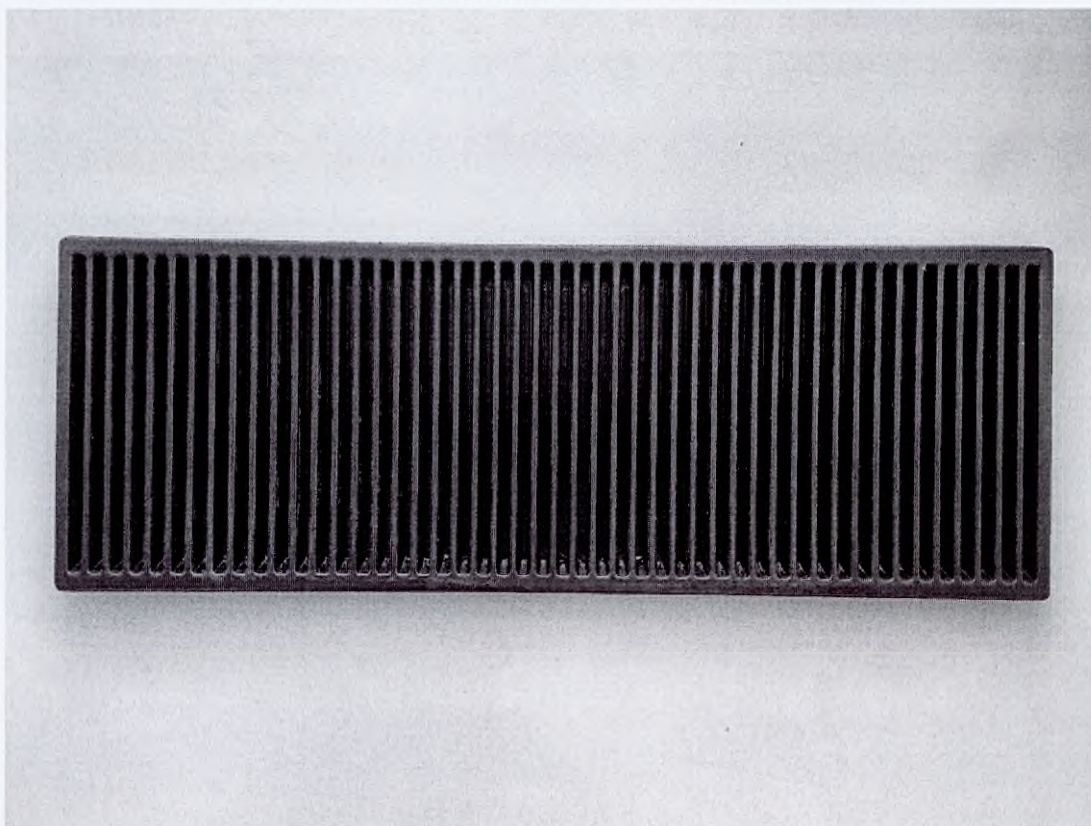

лоток для анализатора «BeeBlot» на 48 ячеек (артикул А-1-0103)

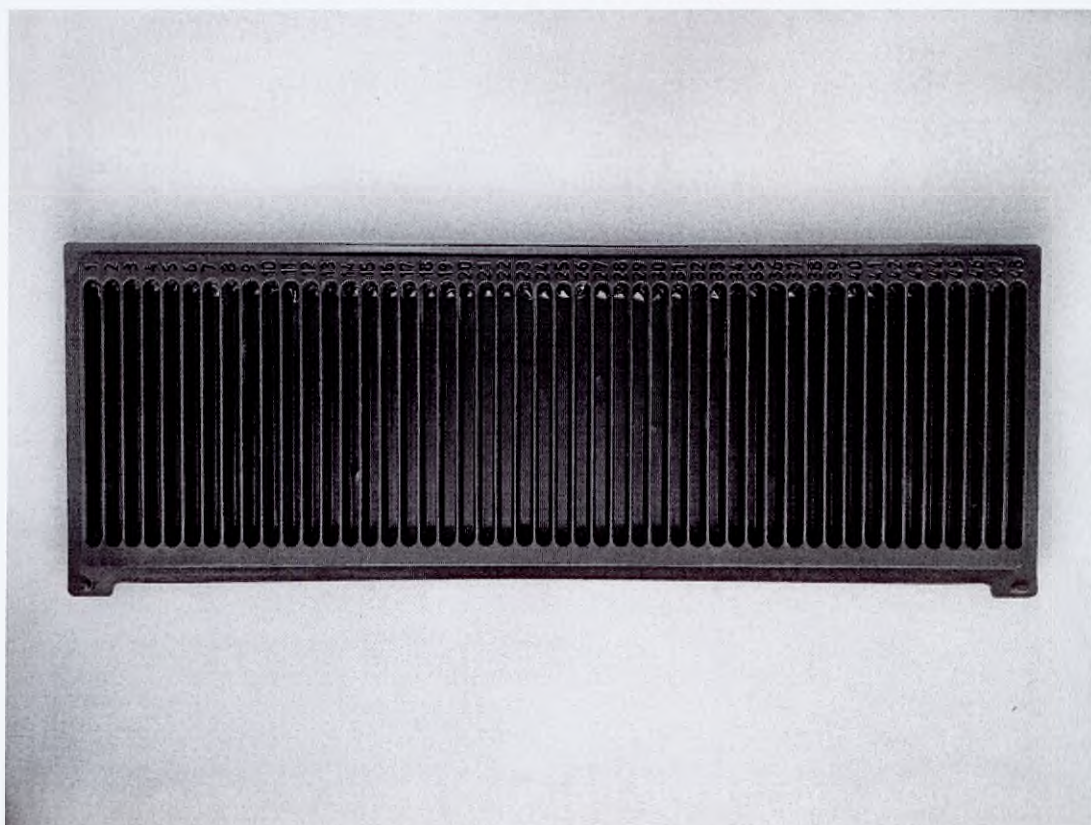

Образец маркировки лотка для анализатора «AutoBlot 3000» на 20 ячеек (артикул А-1-0101)

Лоток полимерный для медицинских лабораторий по ТУ 32.50.50-002-01813981-2019

Лоток для анализатора «AutoBlot 3000» на 20 ячеек (артикул А-1-0101)

 ООО «ПКФ Современные Технологии»
633009 Область Новосибирская, г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 64, кв. 42
артикул: А-1-0101
кол-во: 1 шт.

 05.2019 г.
срок годности: 60 месяцев с даты изготовления

 SN М-01-042-01

РУ № _____ от _____

условия утилизации: изделие класса Б (СанПиН 2.1.7.2790-10)

условия хранения: от + 10 °С до + 40 °С и
относительной влажности воздуха до 90%