

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ОЛИМПИК»

15 мая 2024 г. Самошин И. А.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия

**Рукоять ларингоскопа KAWE, в вариантах исполнения, с
принадлежностями**


производства

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
(КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ), Германия


1. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В малая, артикул 03.41005.711




2. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В малая в комплекте с аккумулятором, артикул 03.41105.711

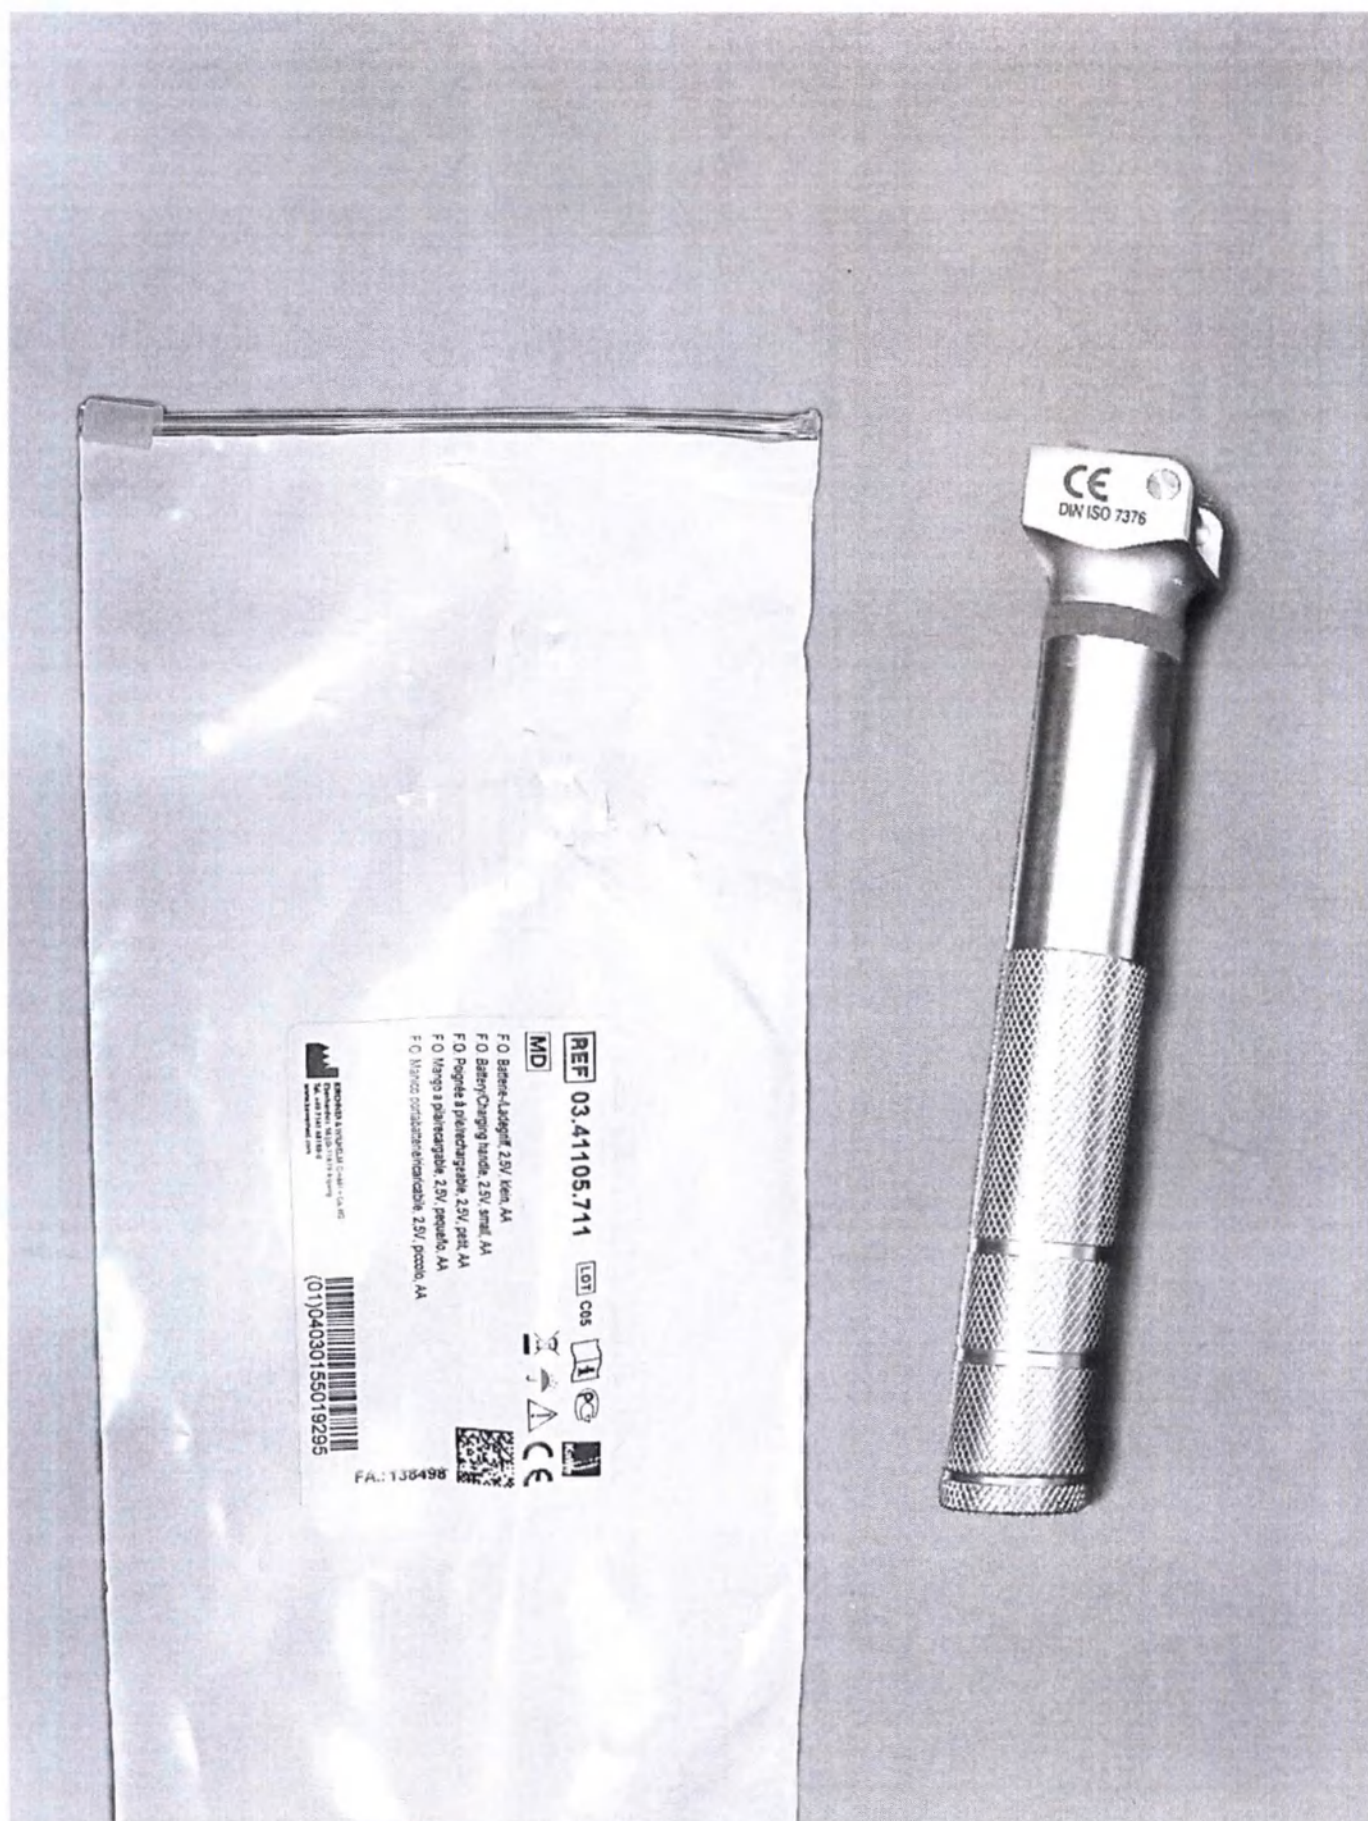


3. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В средняя, артикул 03.41000.721

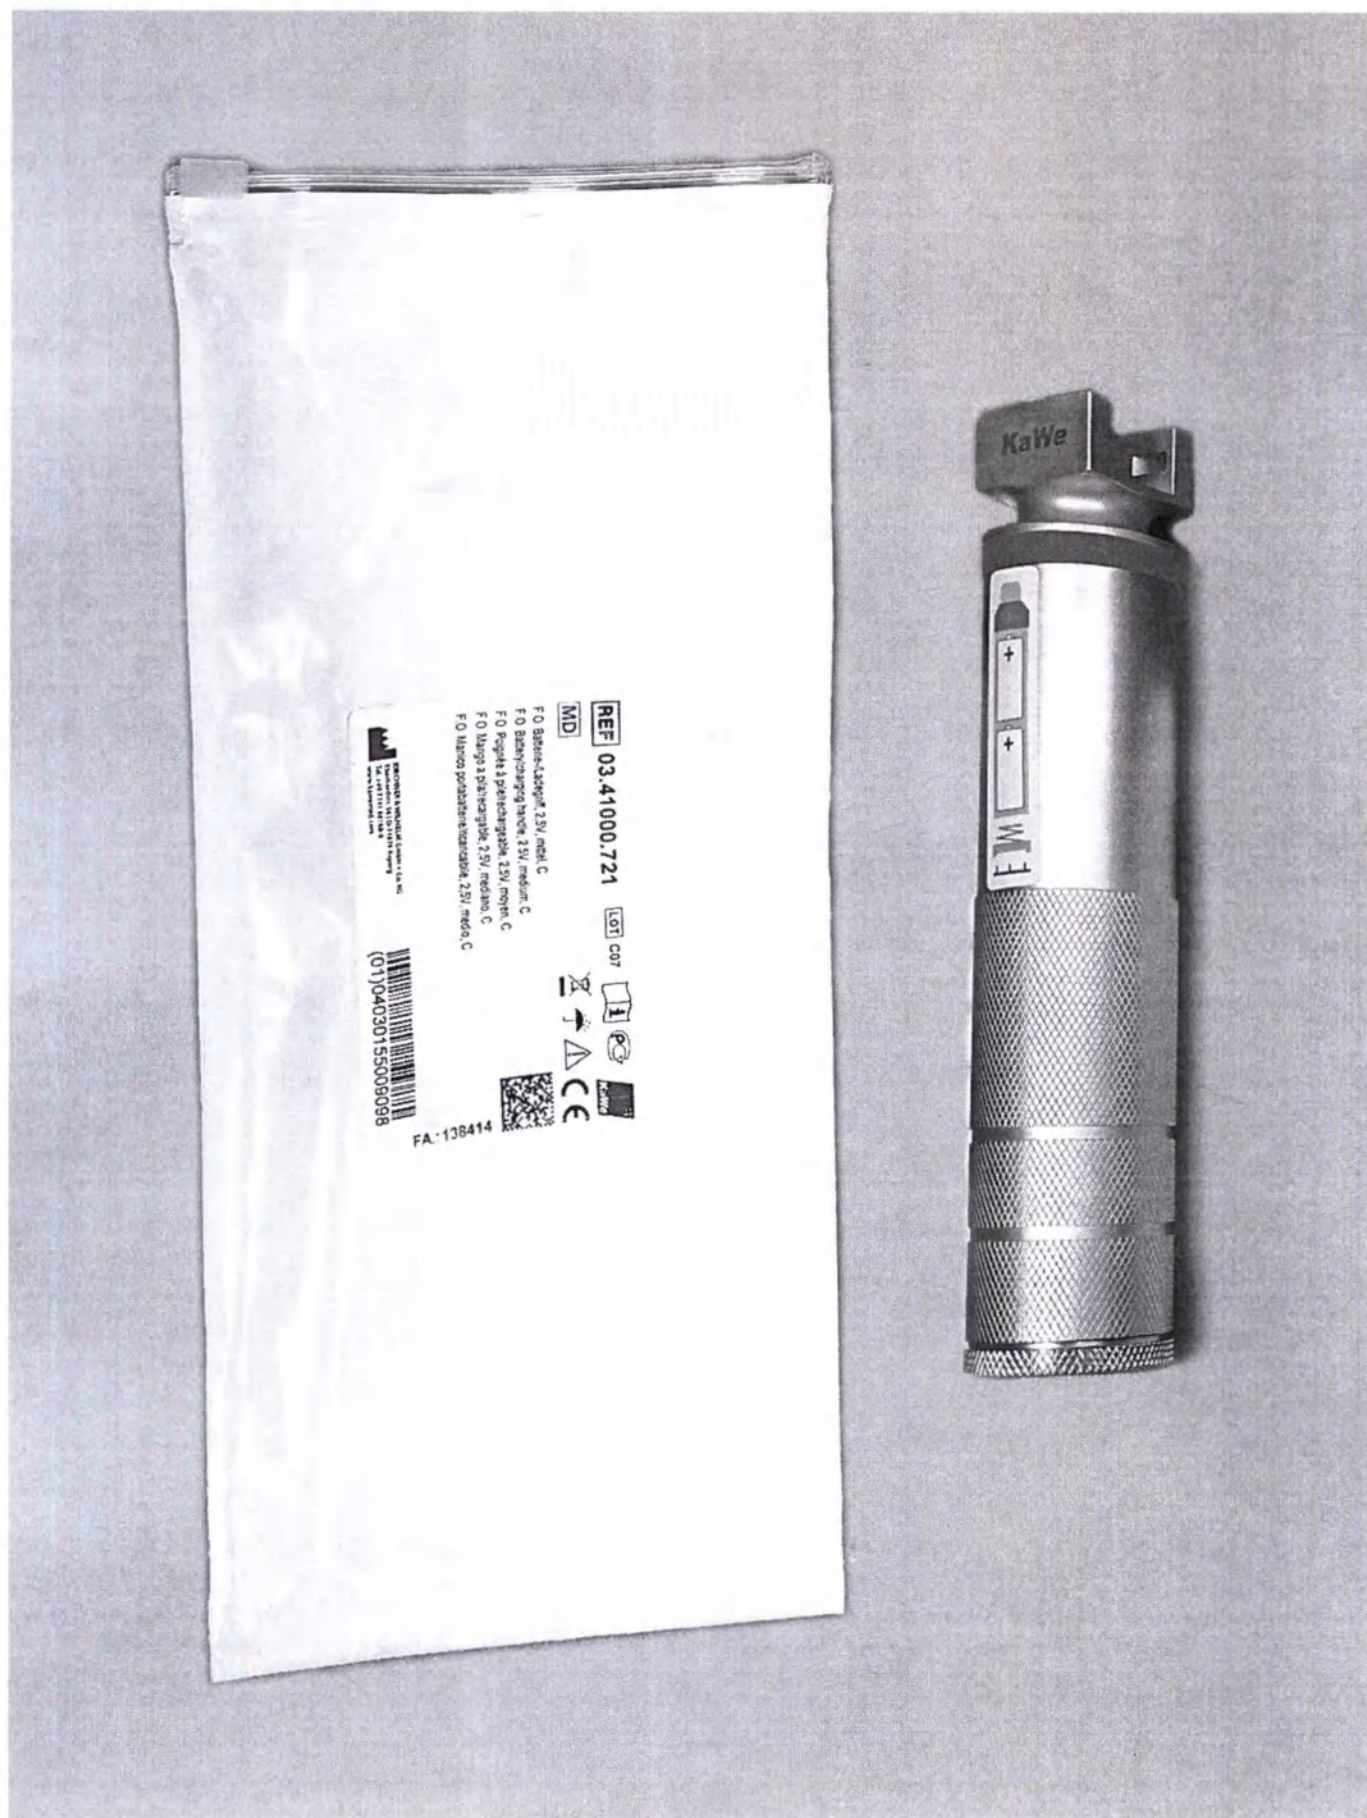


4. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В средняя в комплекте с аккумулятором, артикул 03.41100.721

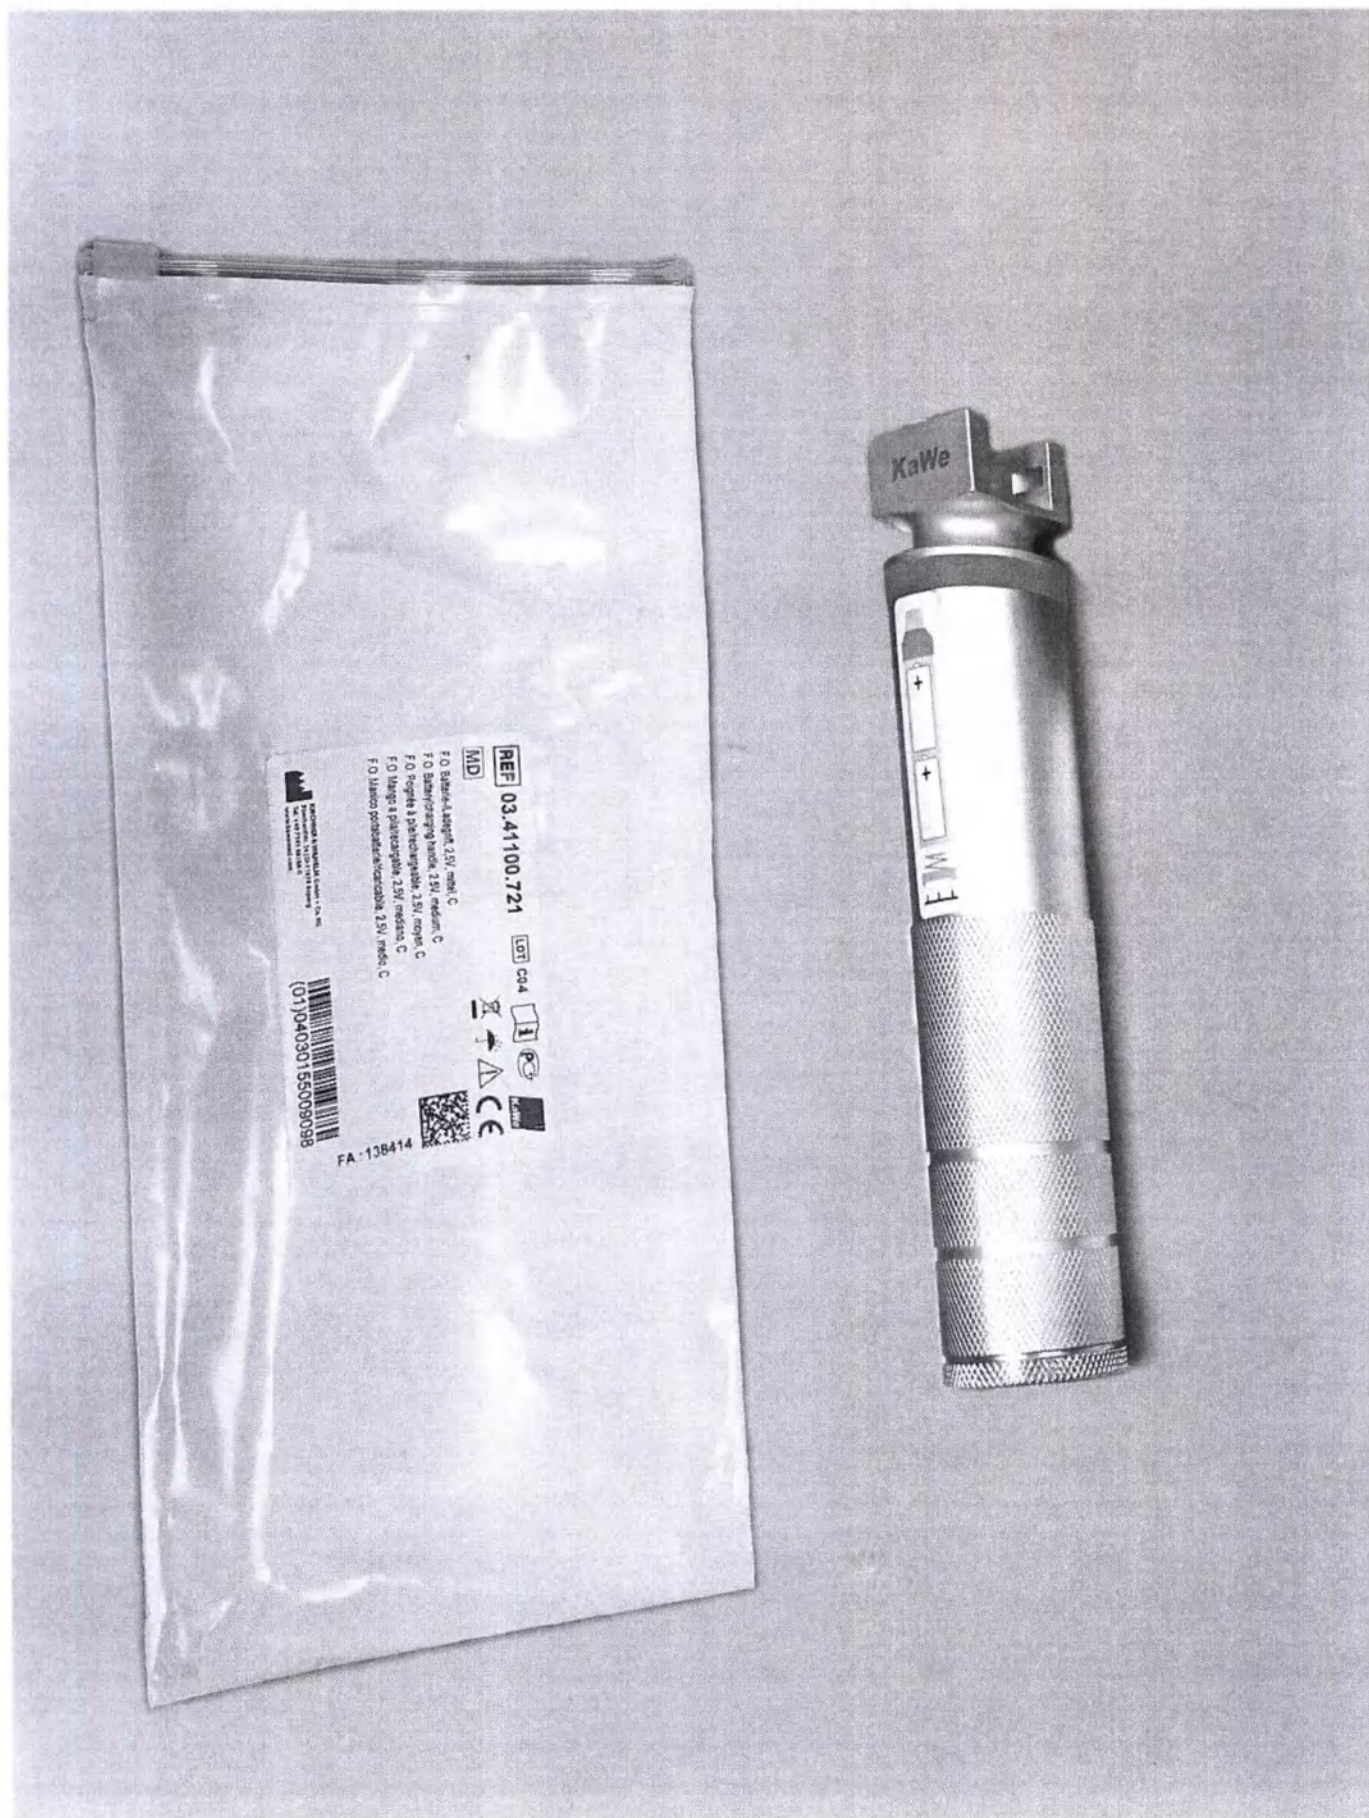


5. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В большая, артикул 03.41000.731

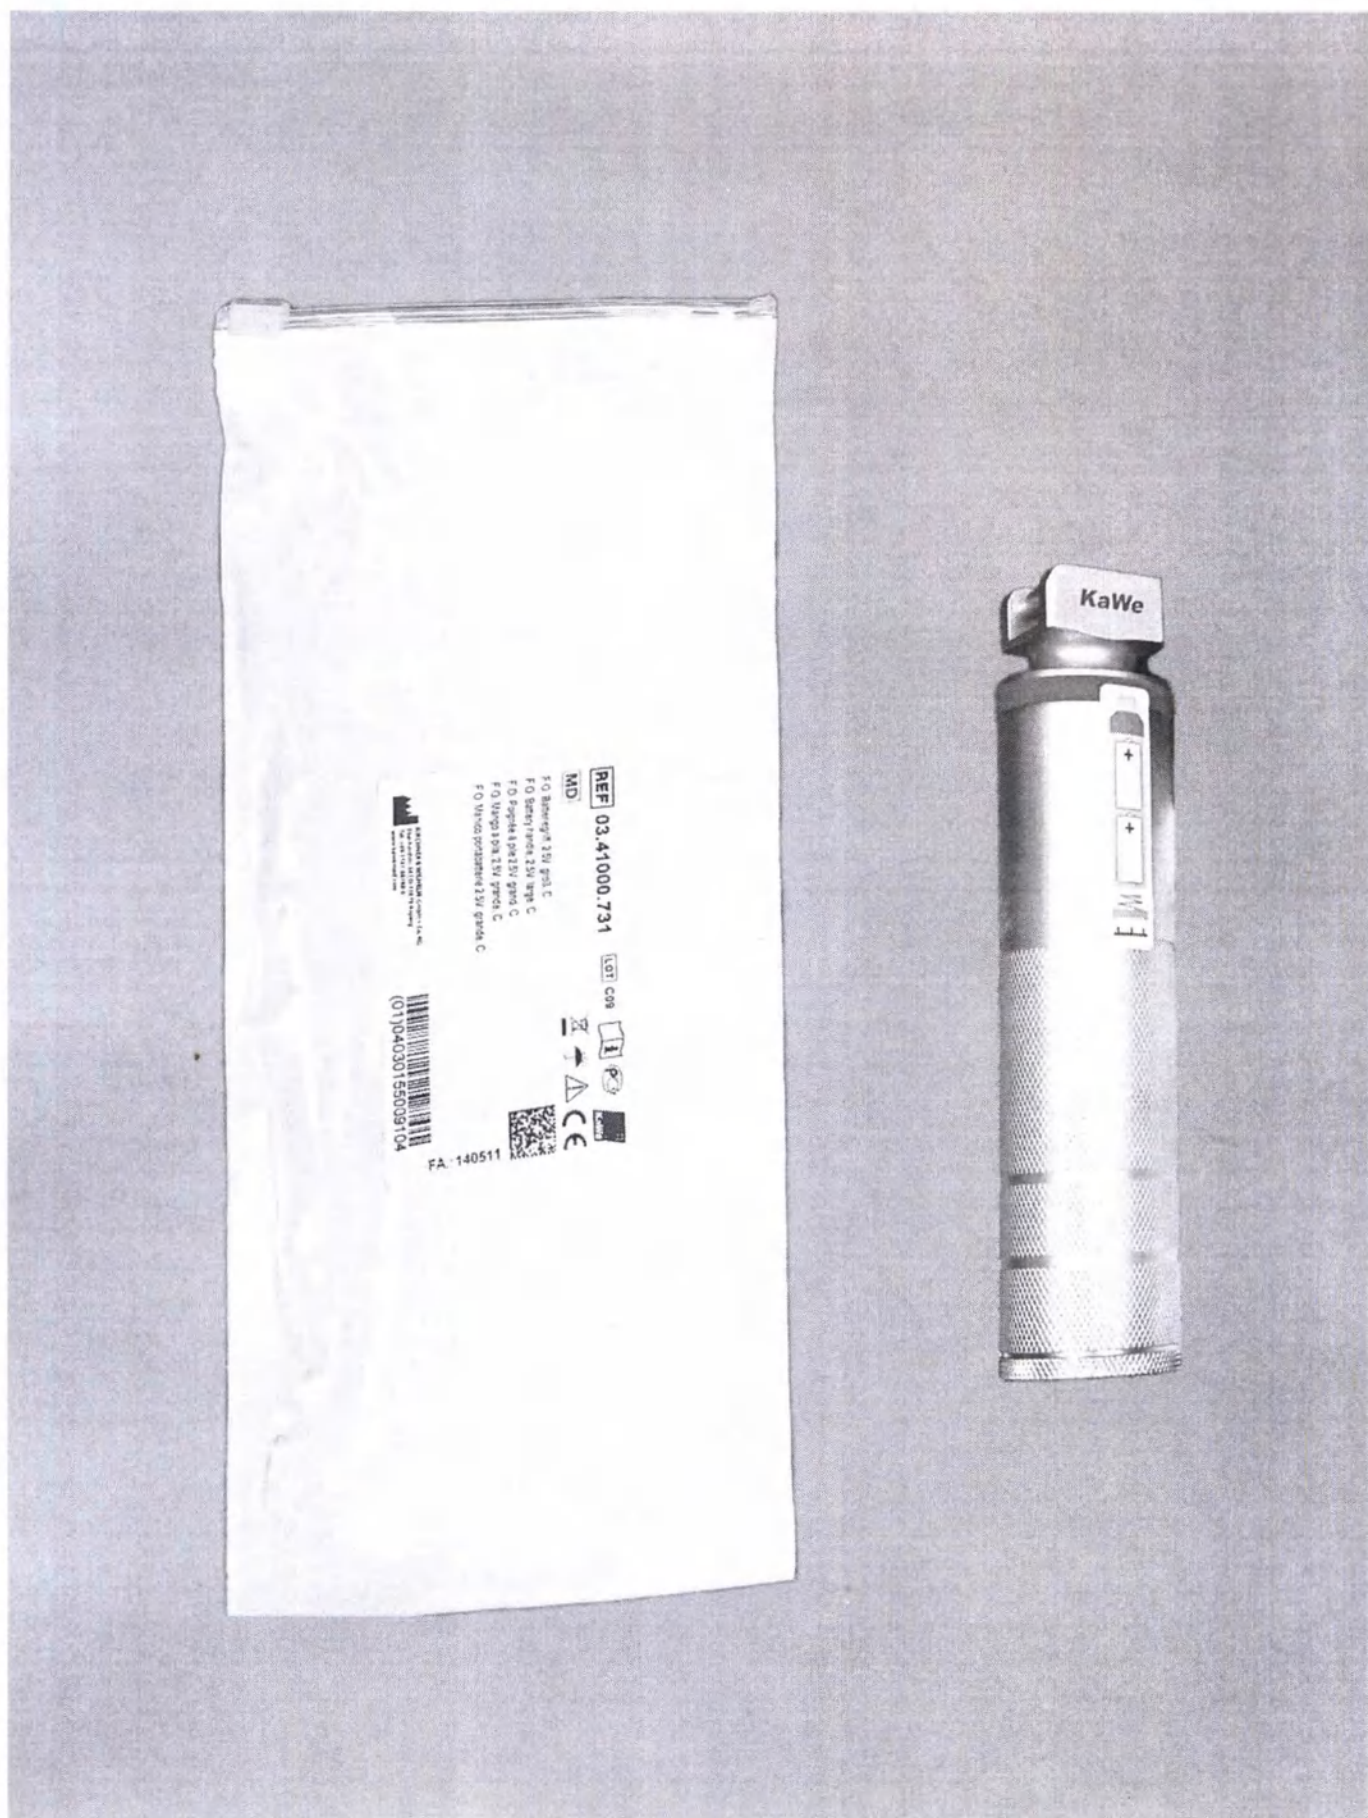


6. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В короткая, артикул 03.41000.741

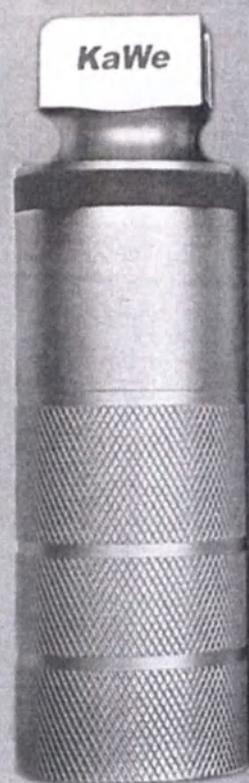

7. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 2,5В средняя эконом,
артикул 03.41001.721

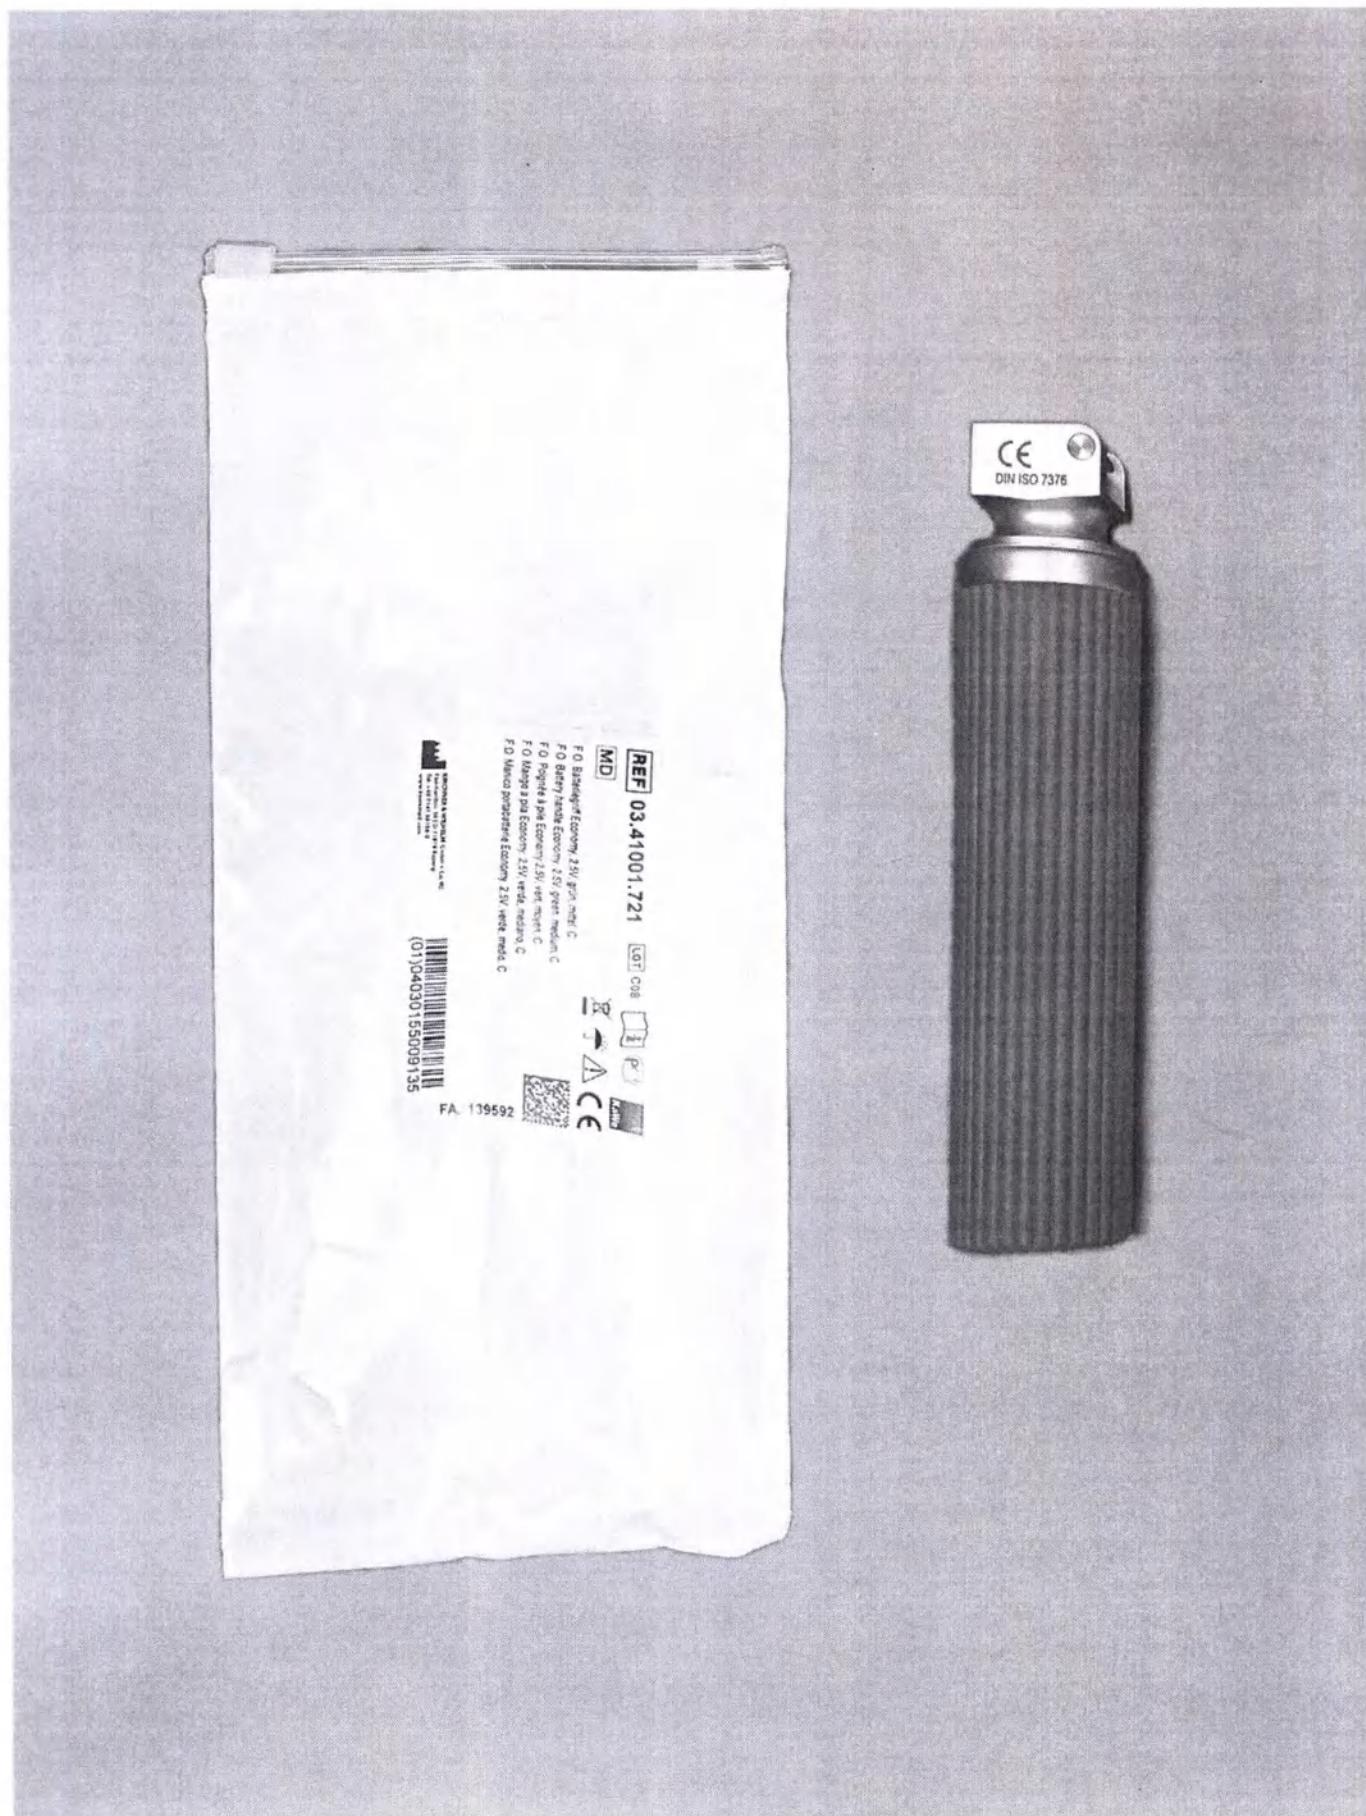


8. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 3,5В малая в комплекте с аккумулятором, артикул 03.41015.711

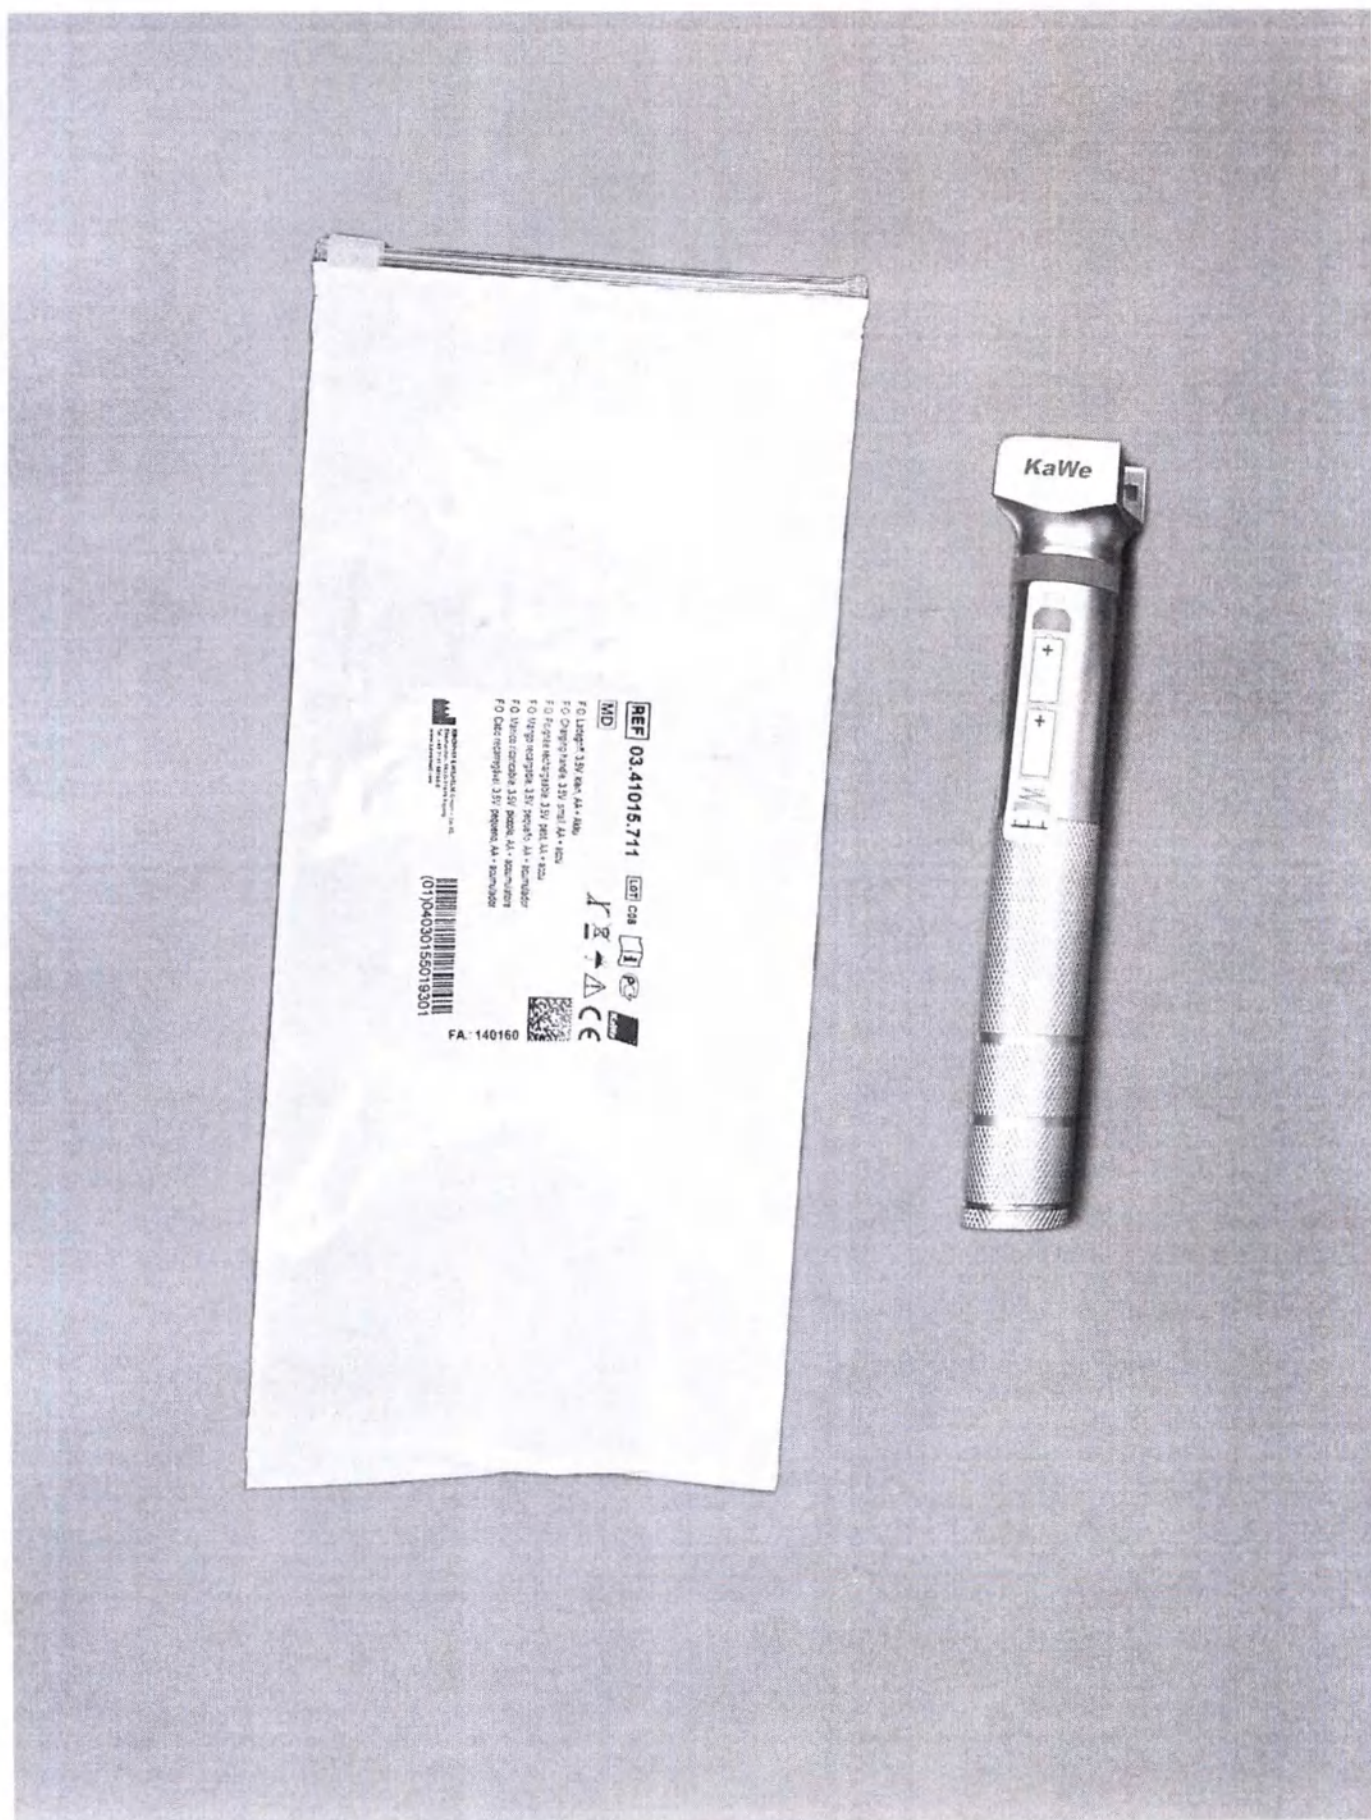


9. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 3,5В средняя в комплекте с аккумулятором, артикул 03.41010.521



10. Рукоять фиброоптическая с ксеноновым освещением 3,5В средняя в комплекте с аккумулятором и со встроенной вилкой, артикул 03.41000.811

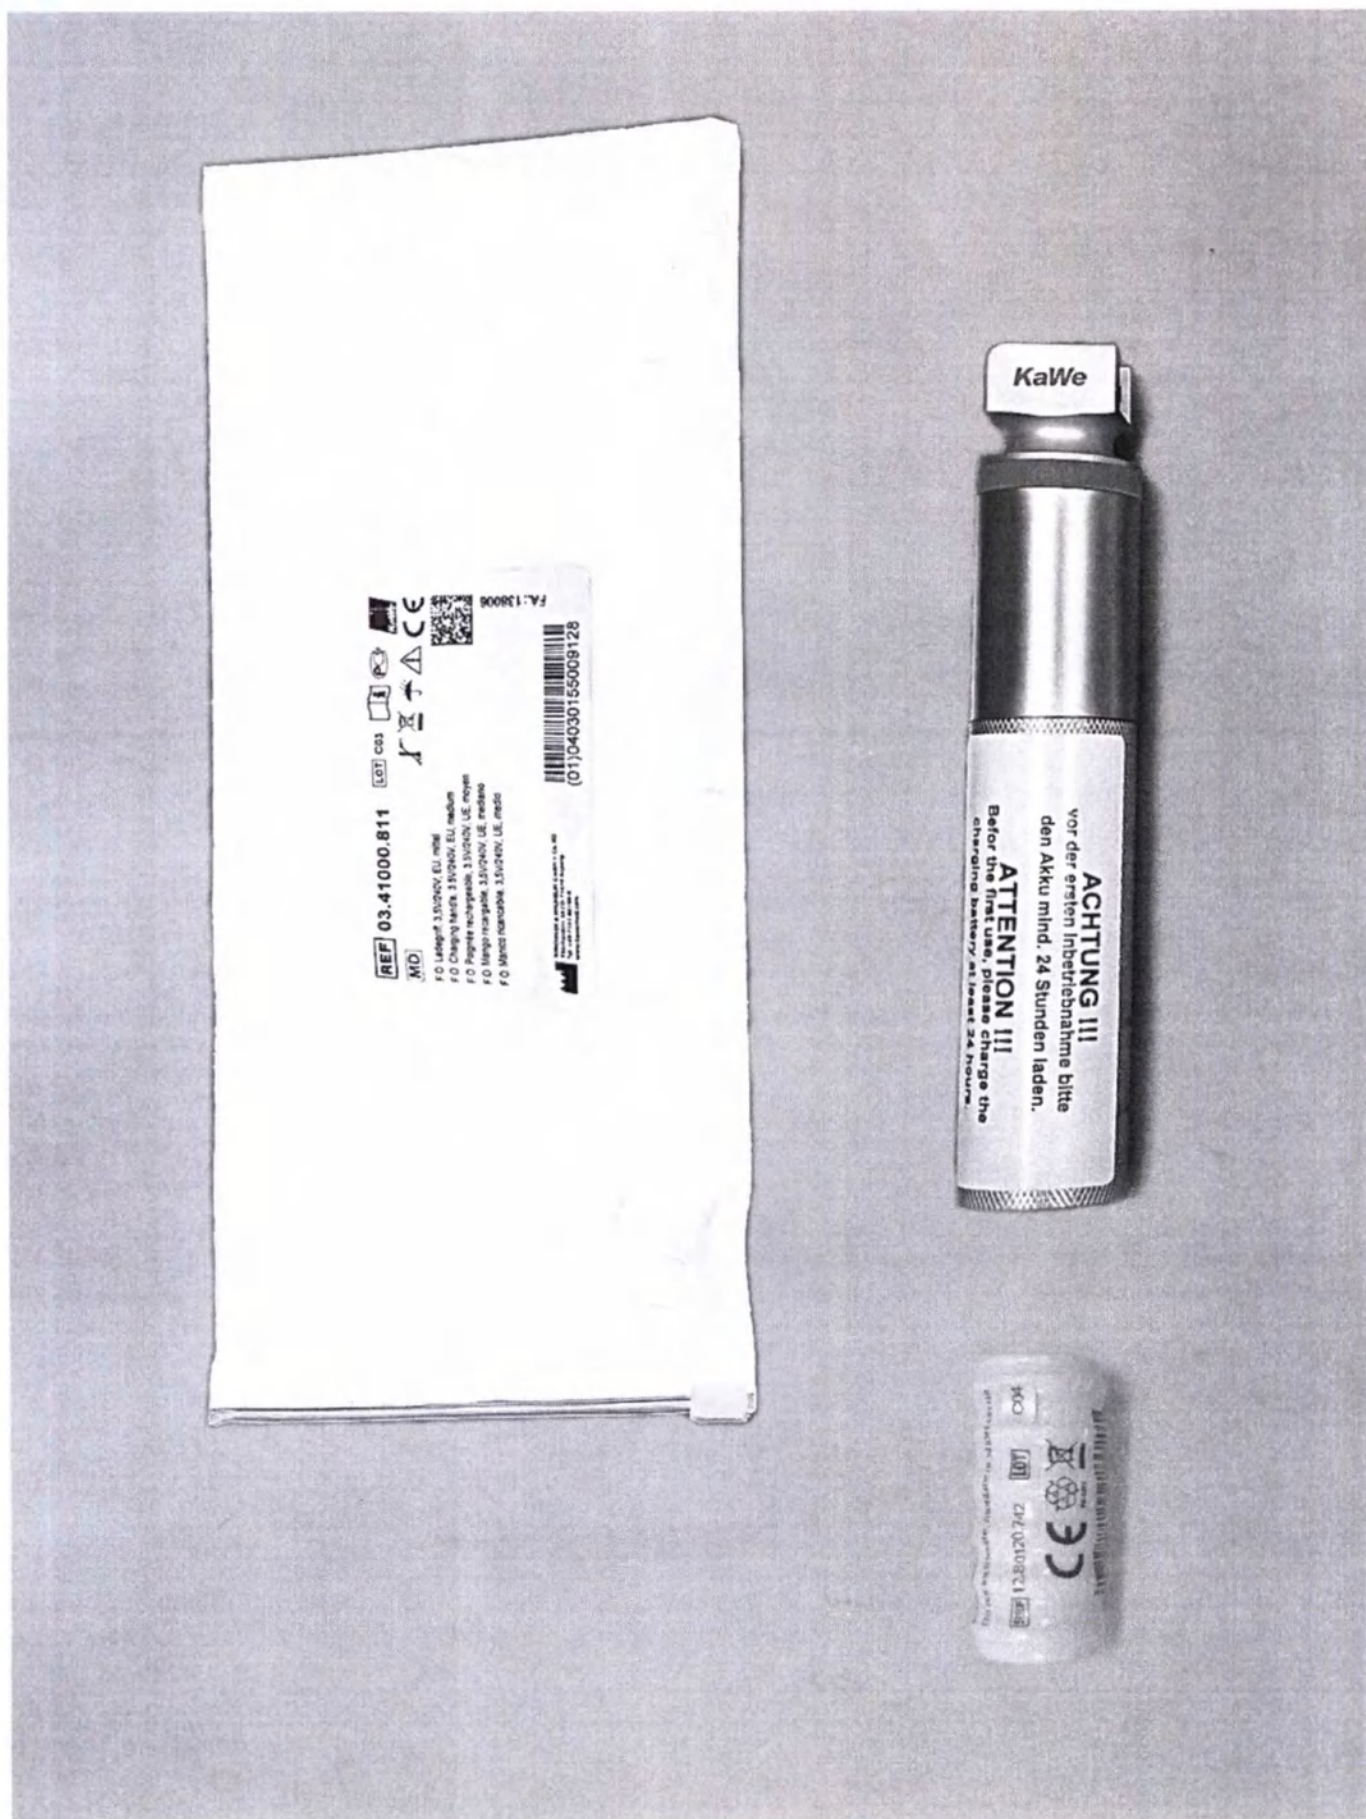


11. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением стандартной яркости 2,5В малая, артикул 03.41020.711

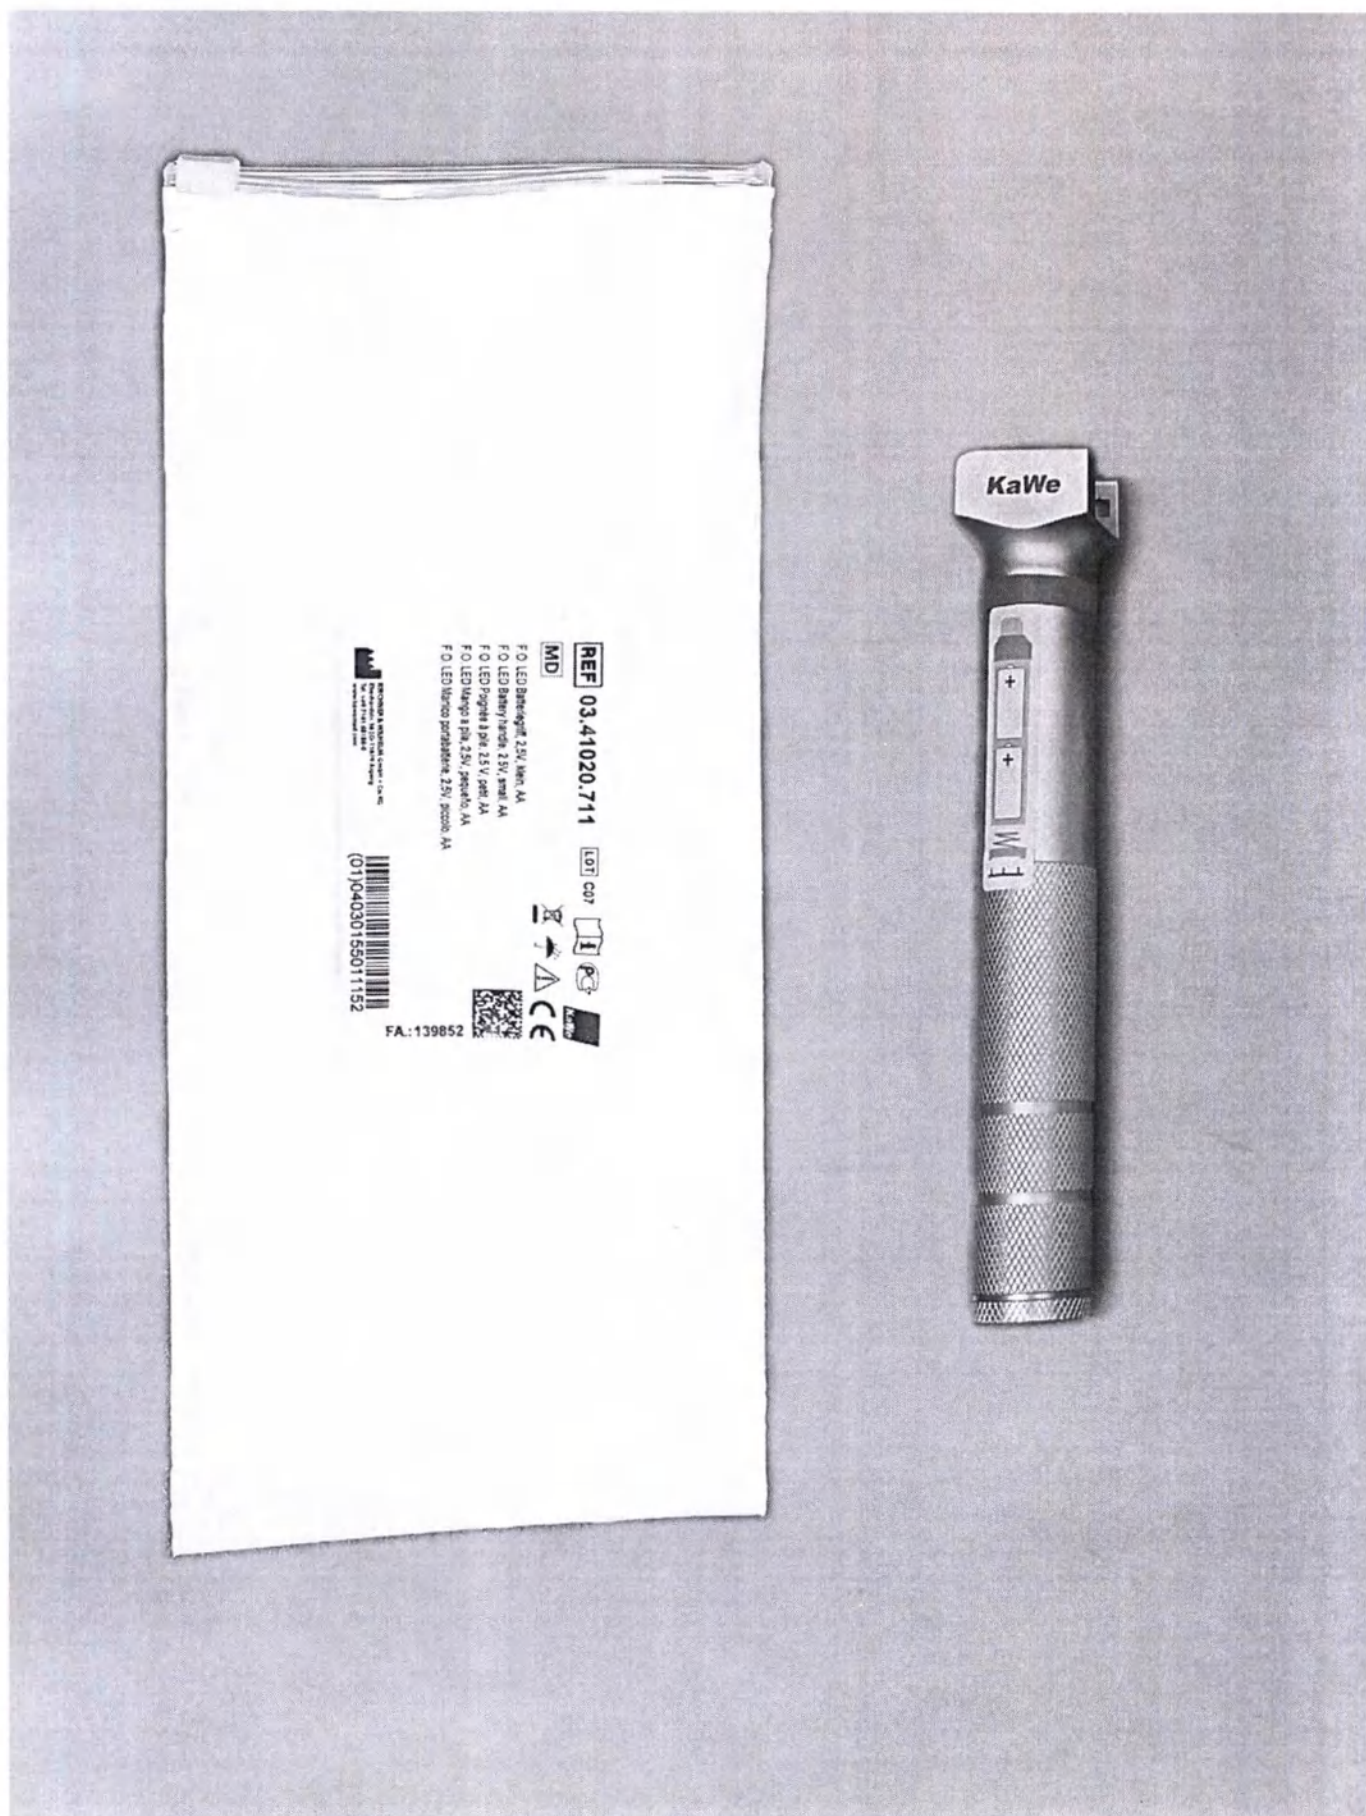


12. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением стандартной яркости 2,5В средняя, артикул 03.41020.721




13. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением стандартной яркости 2,5В короткая, артикул 03.41020.741

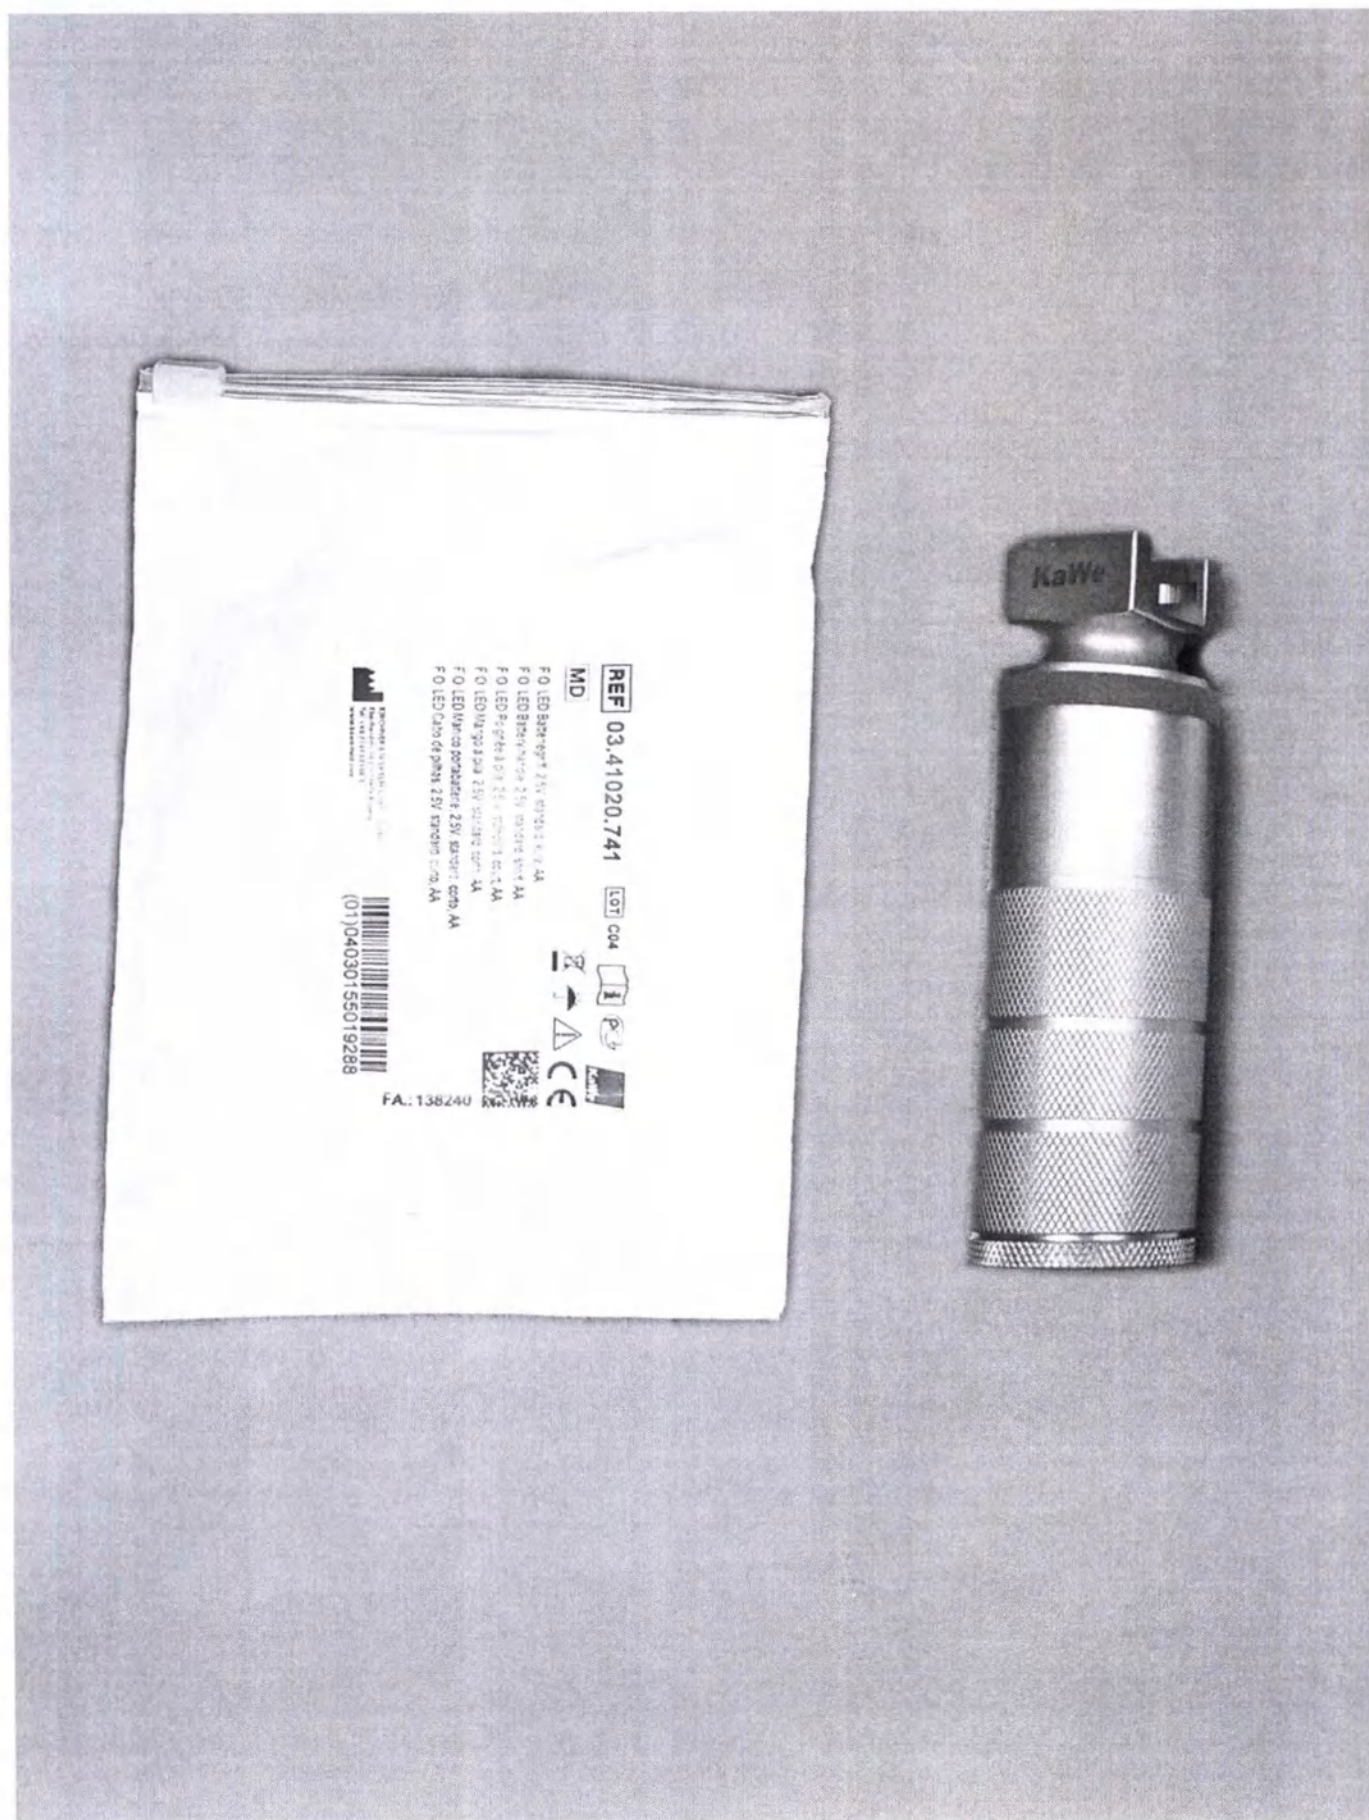

14. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением повышенной яркости 2,5В малая, артикул 03.41030.711

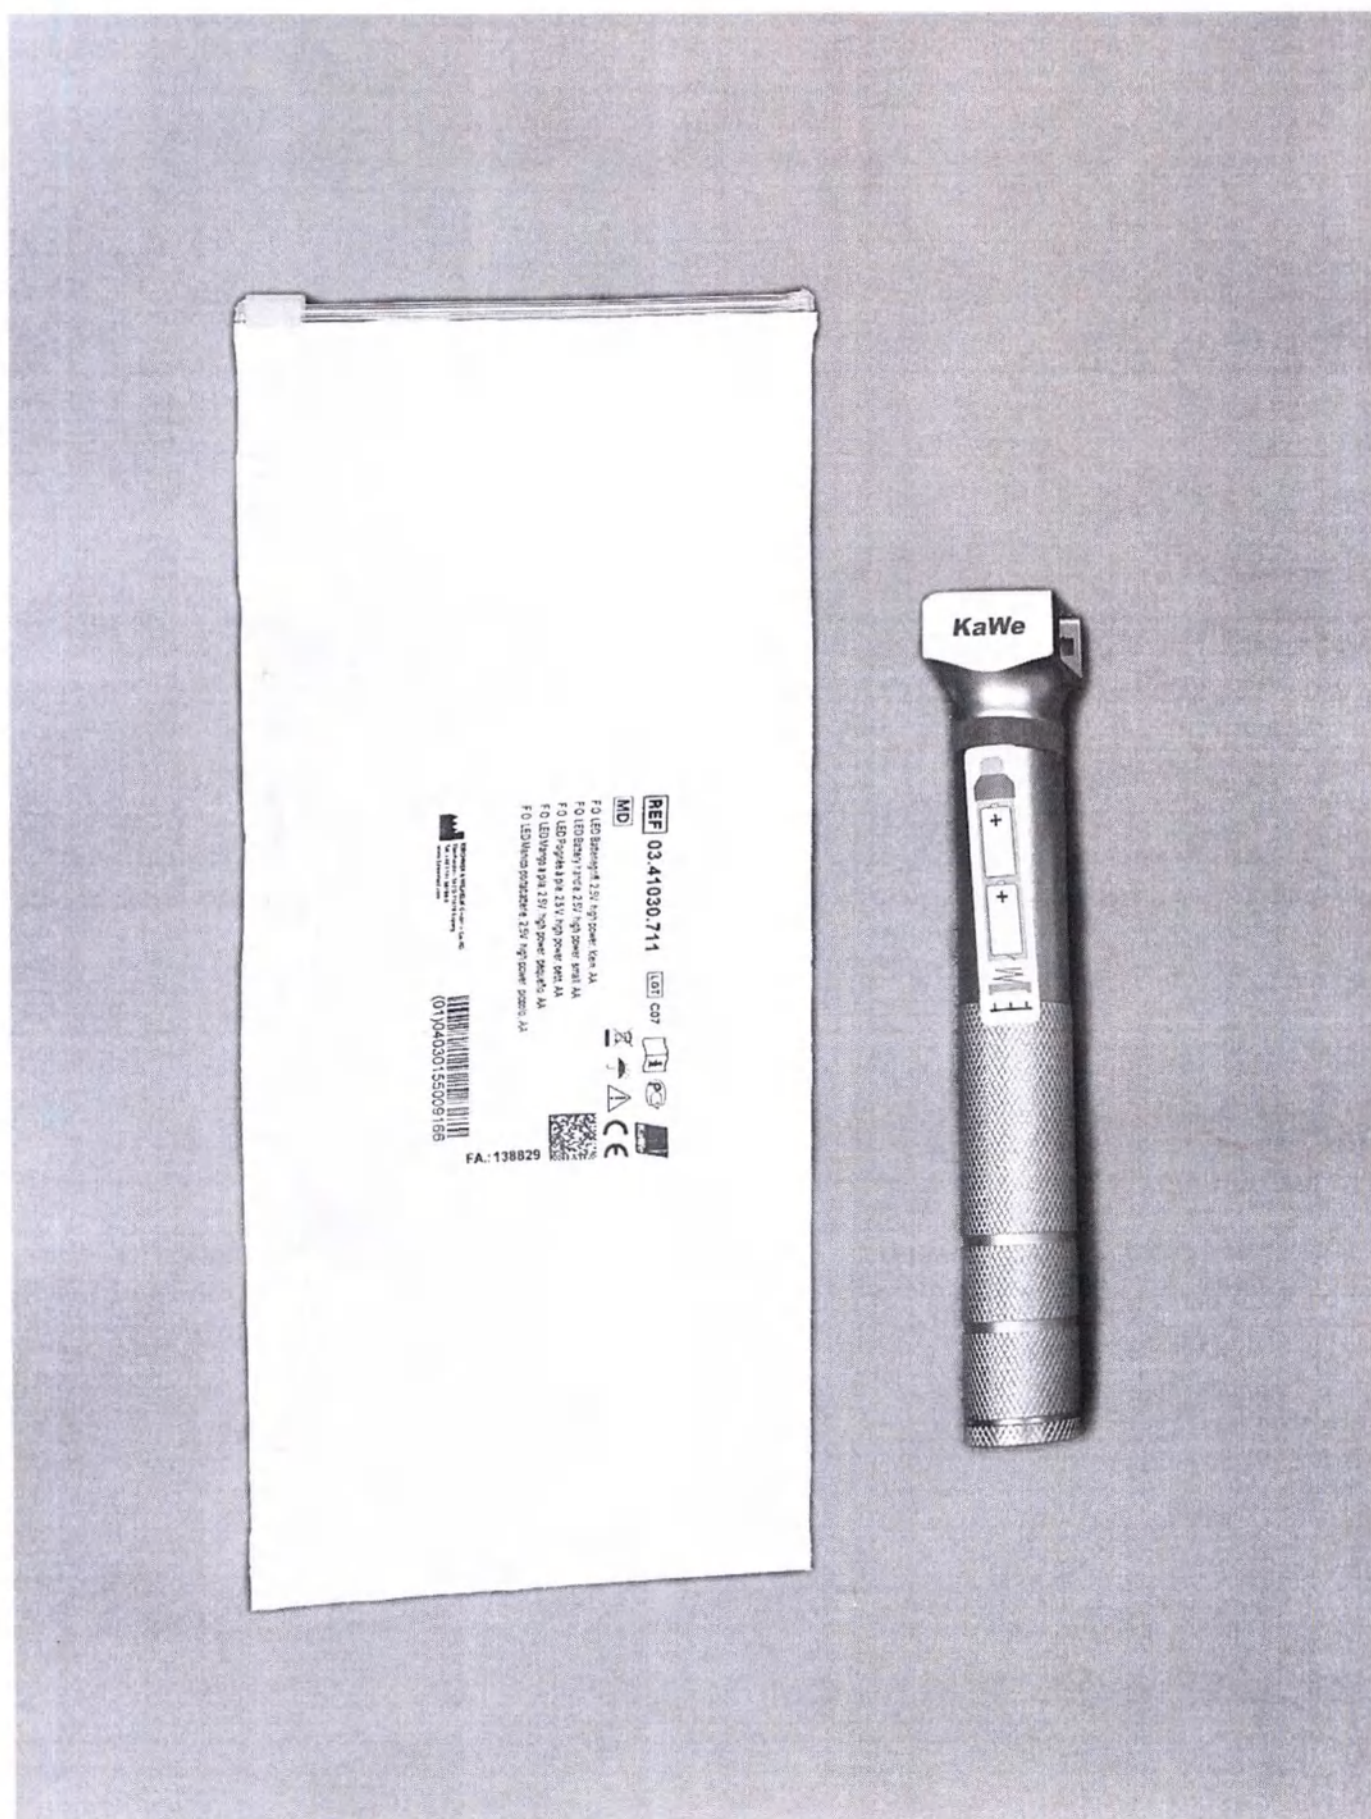


15. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением повышенной яркости
2,5В средняя, артикул 03.41030.721

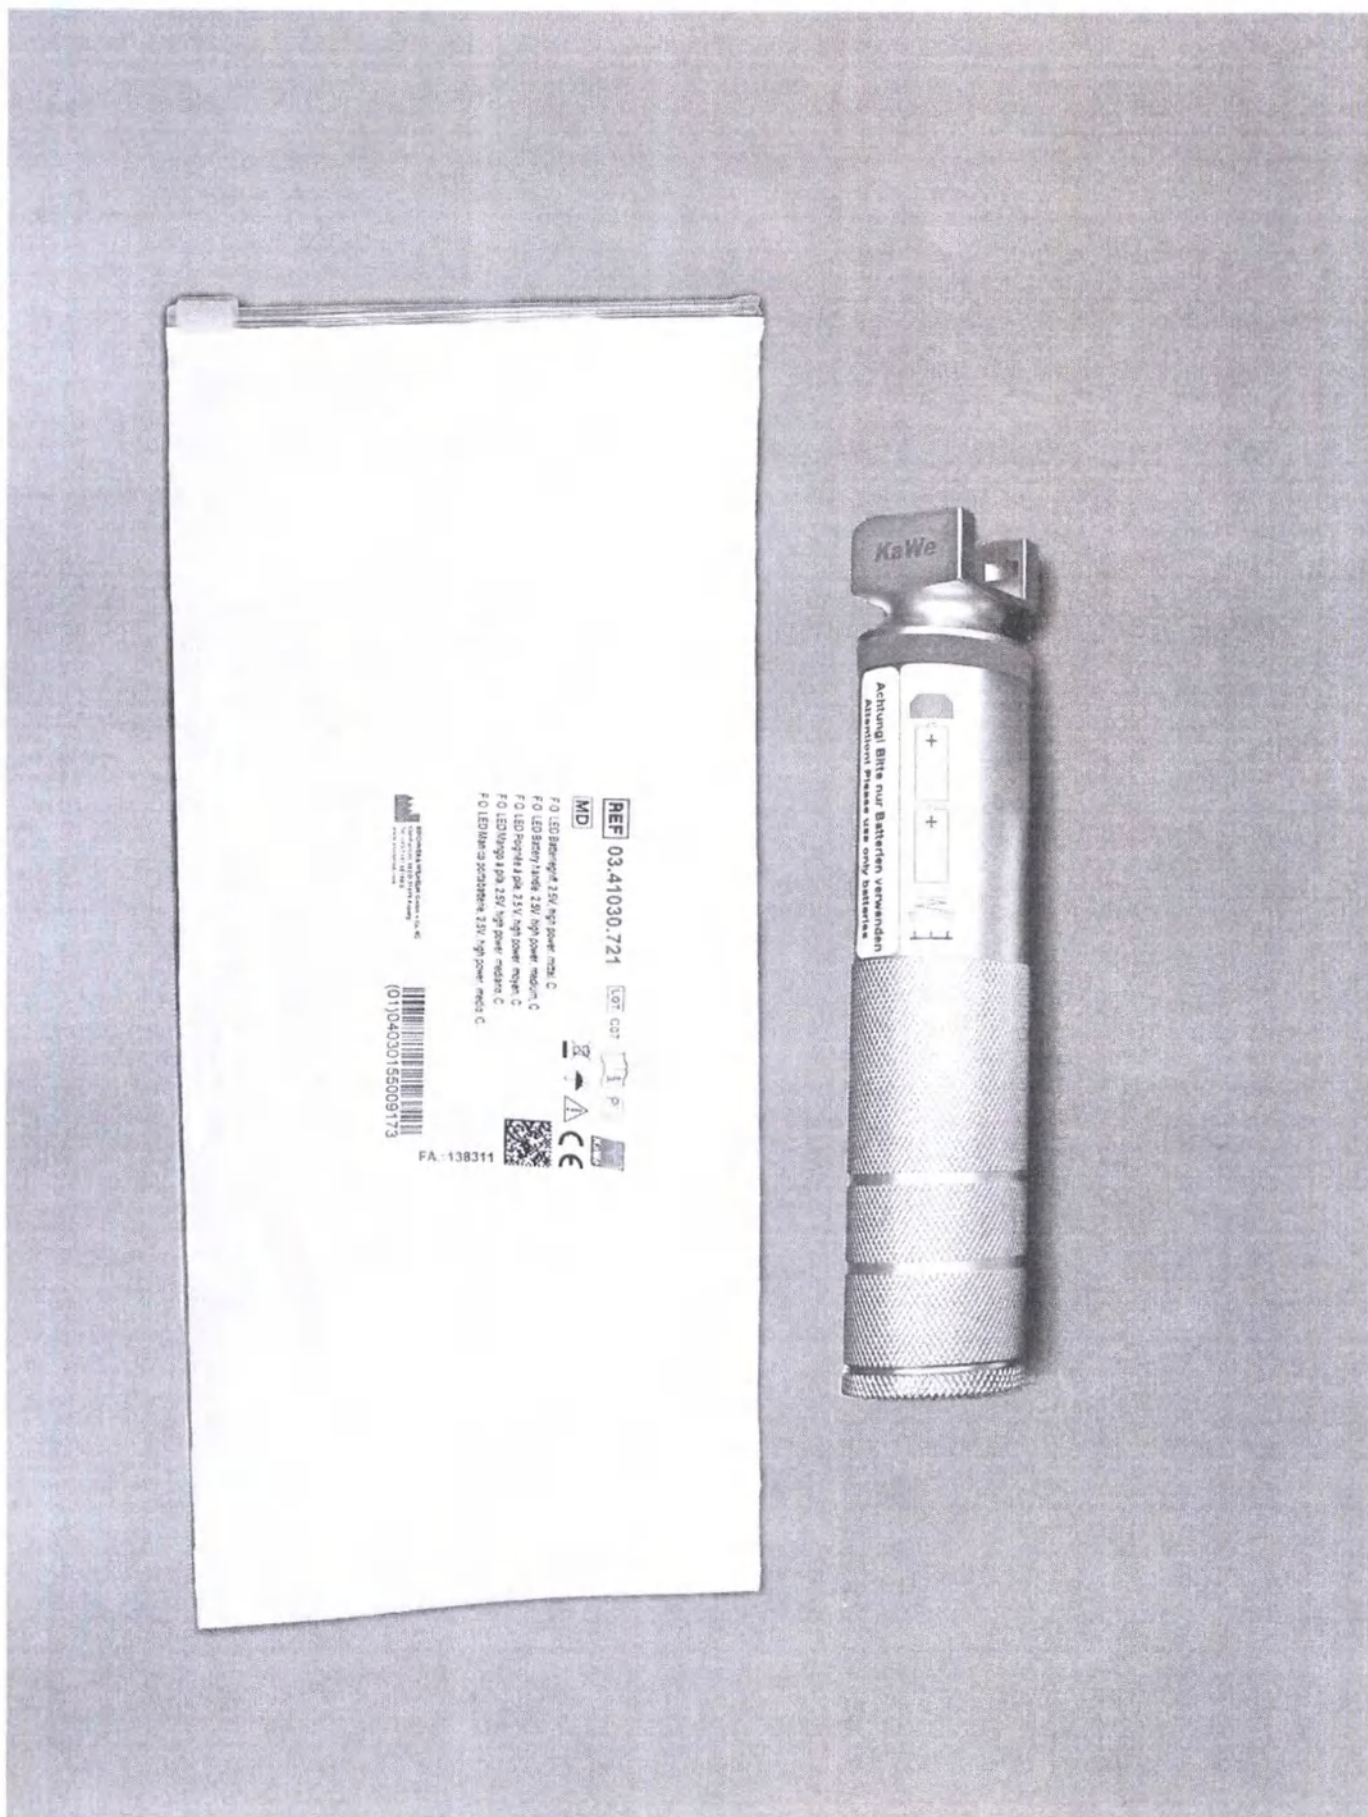


16. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением повышенной яркости 2,5В короткая, артикул 03.41030.741




17. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением повышенной яркости 3,5В малая в комплекте с аккумулятором, артикул 03.41145.711

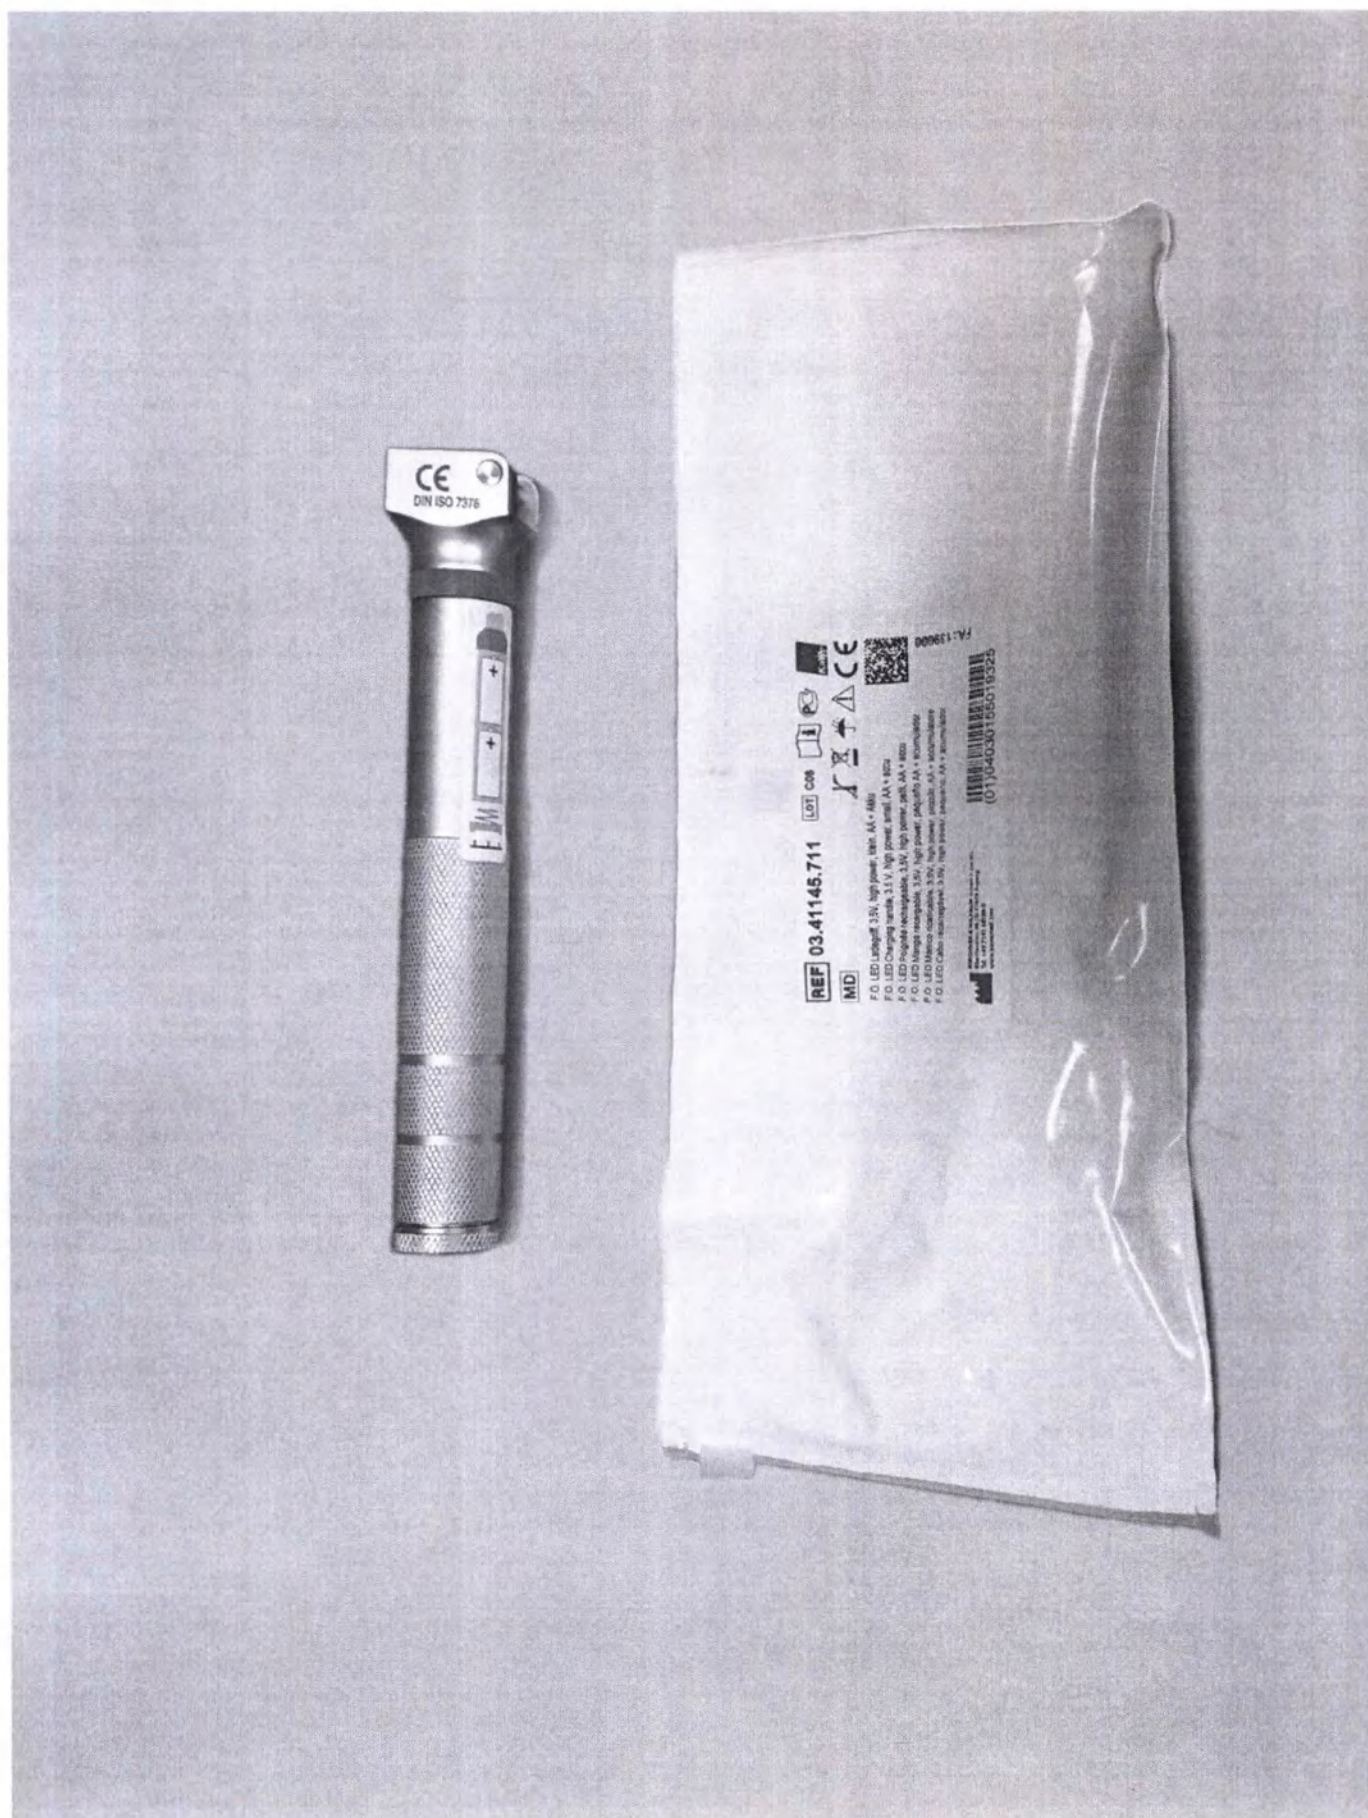


18. Рукоять фиброоптическая со светодиодным освещением повышенной яркости 3,5В средняя в комплекте с аккумулятором, артикул 03.41140.521

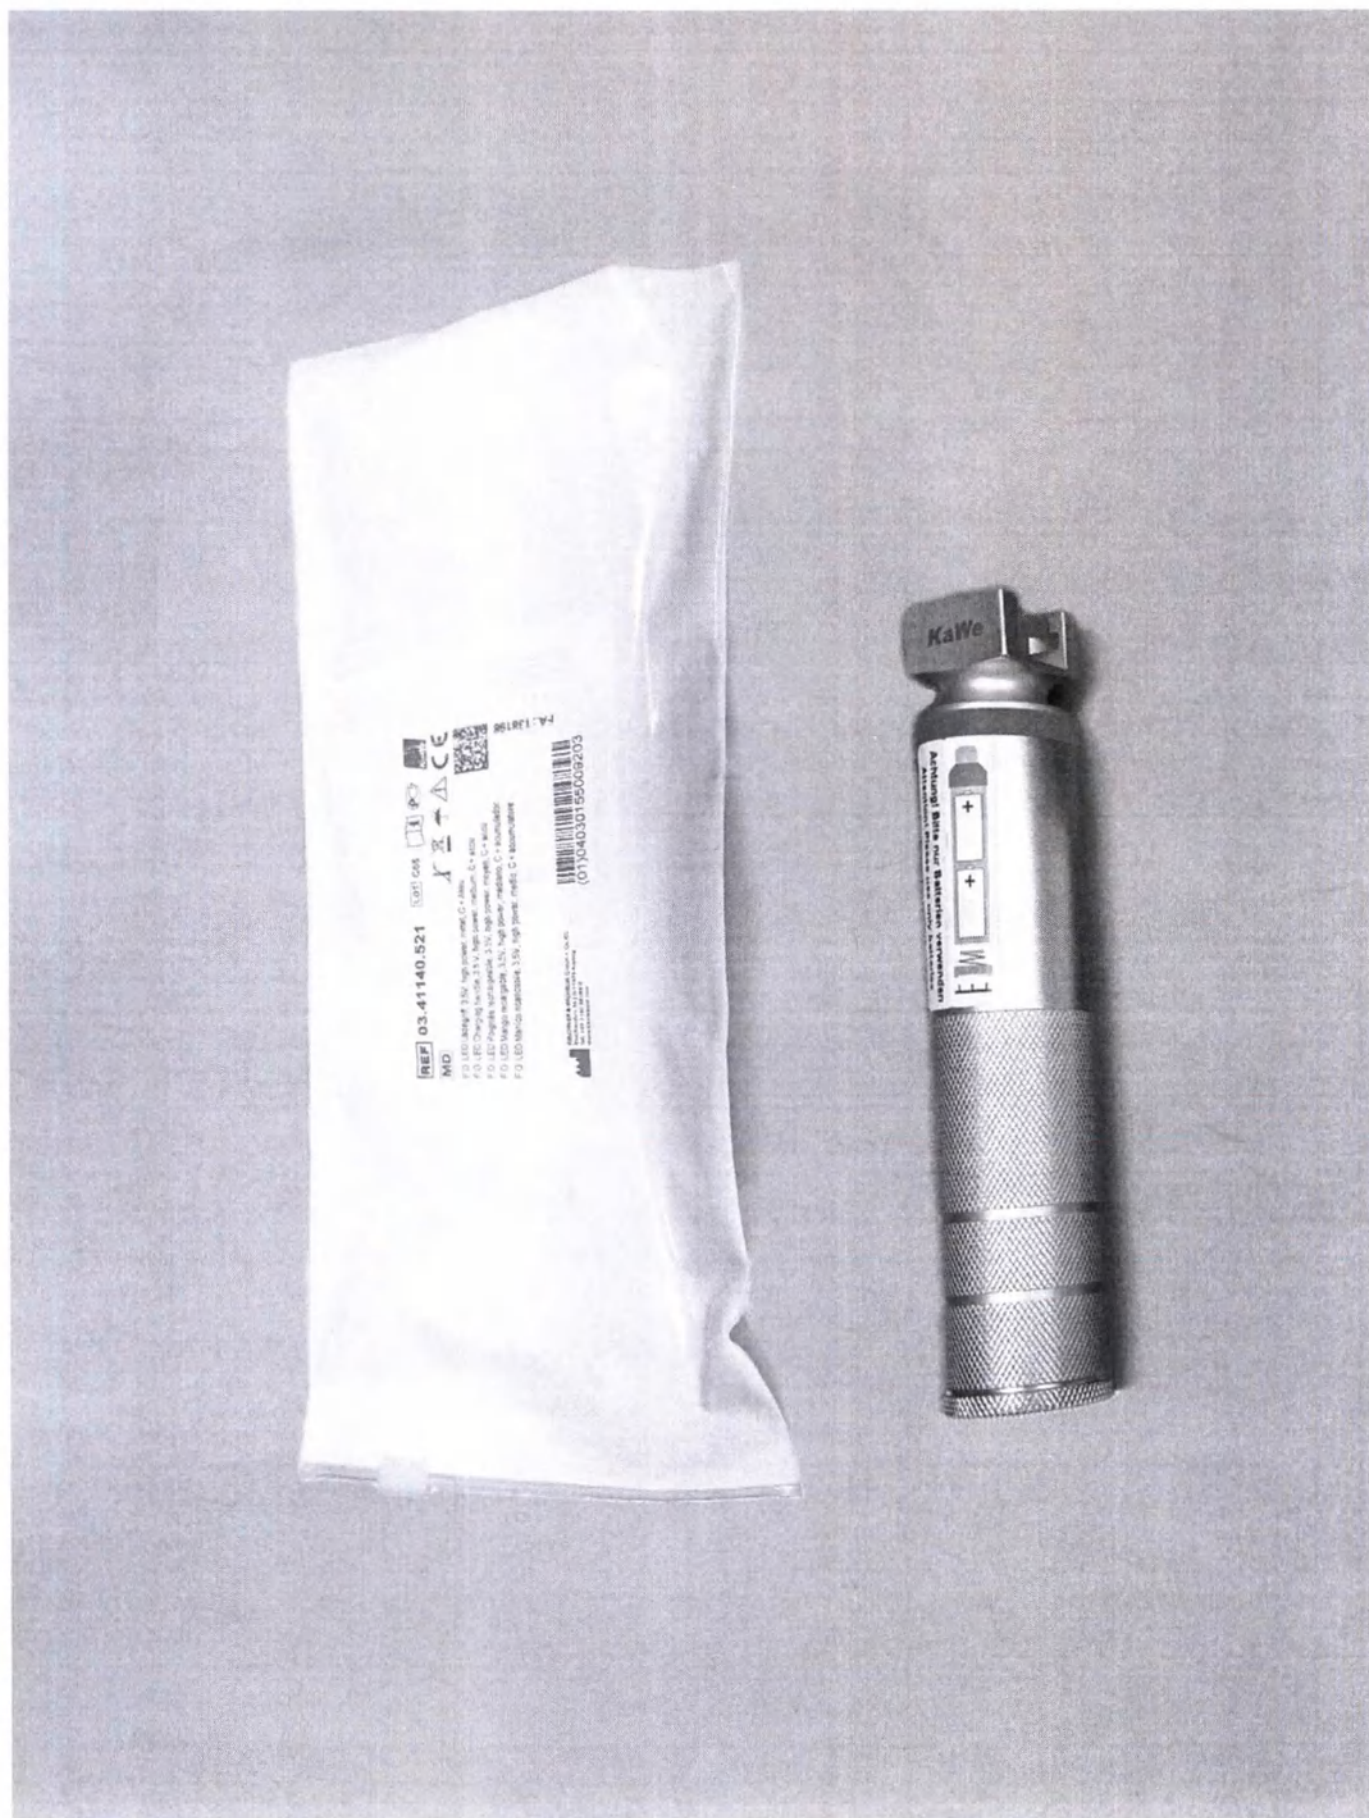


19. Рукоять стандартного освещения 2,5В малая, артикул 03.11000.711

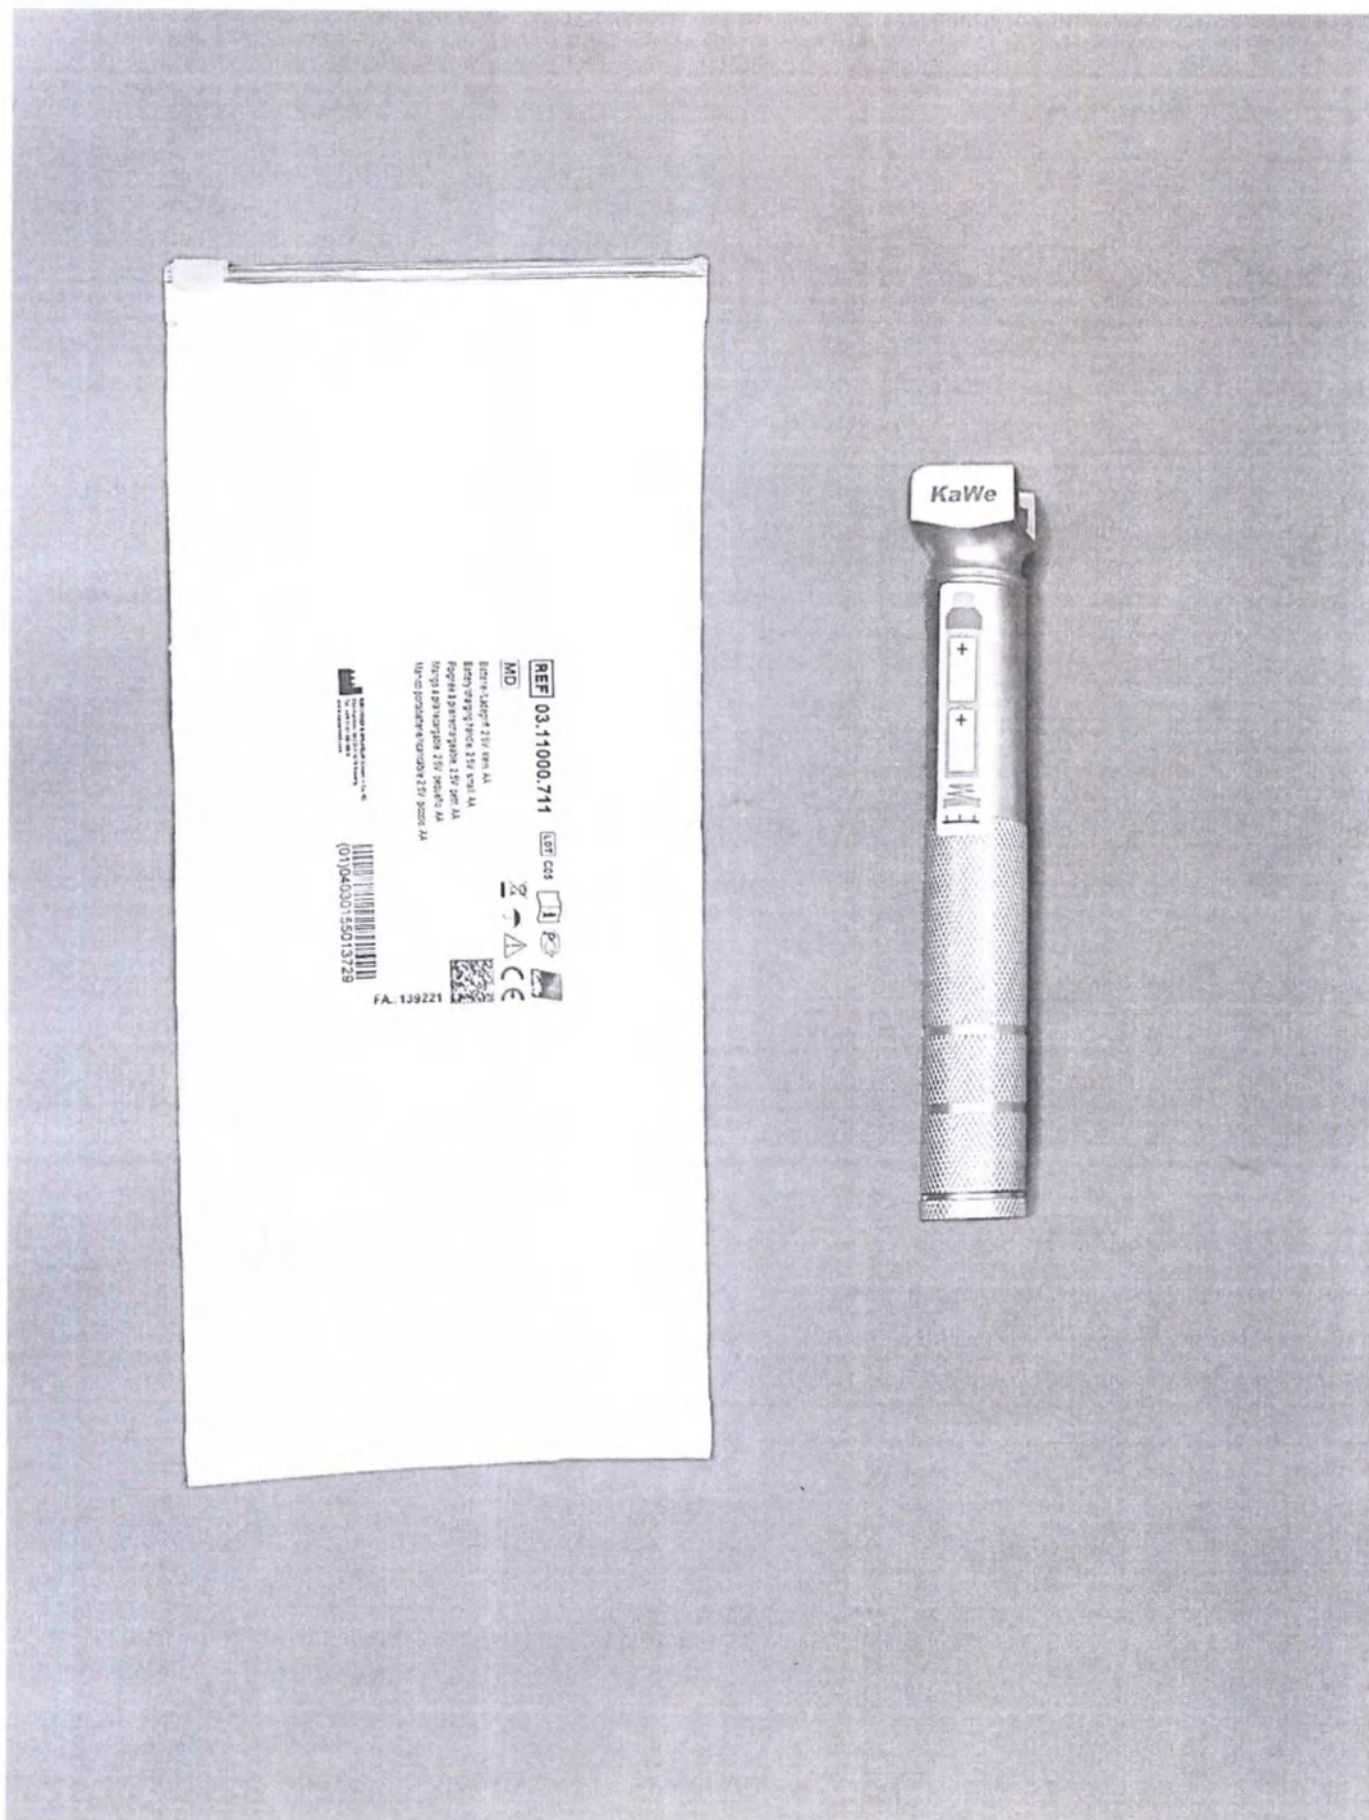

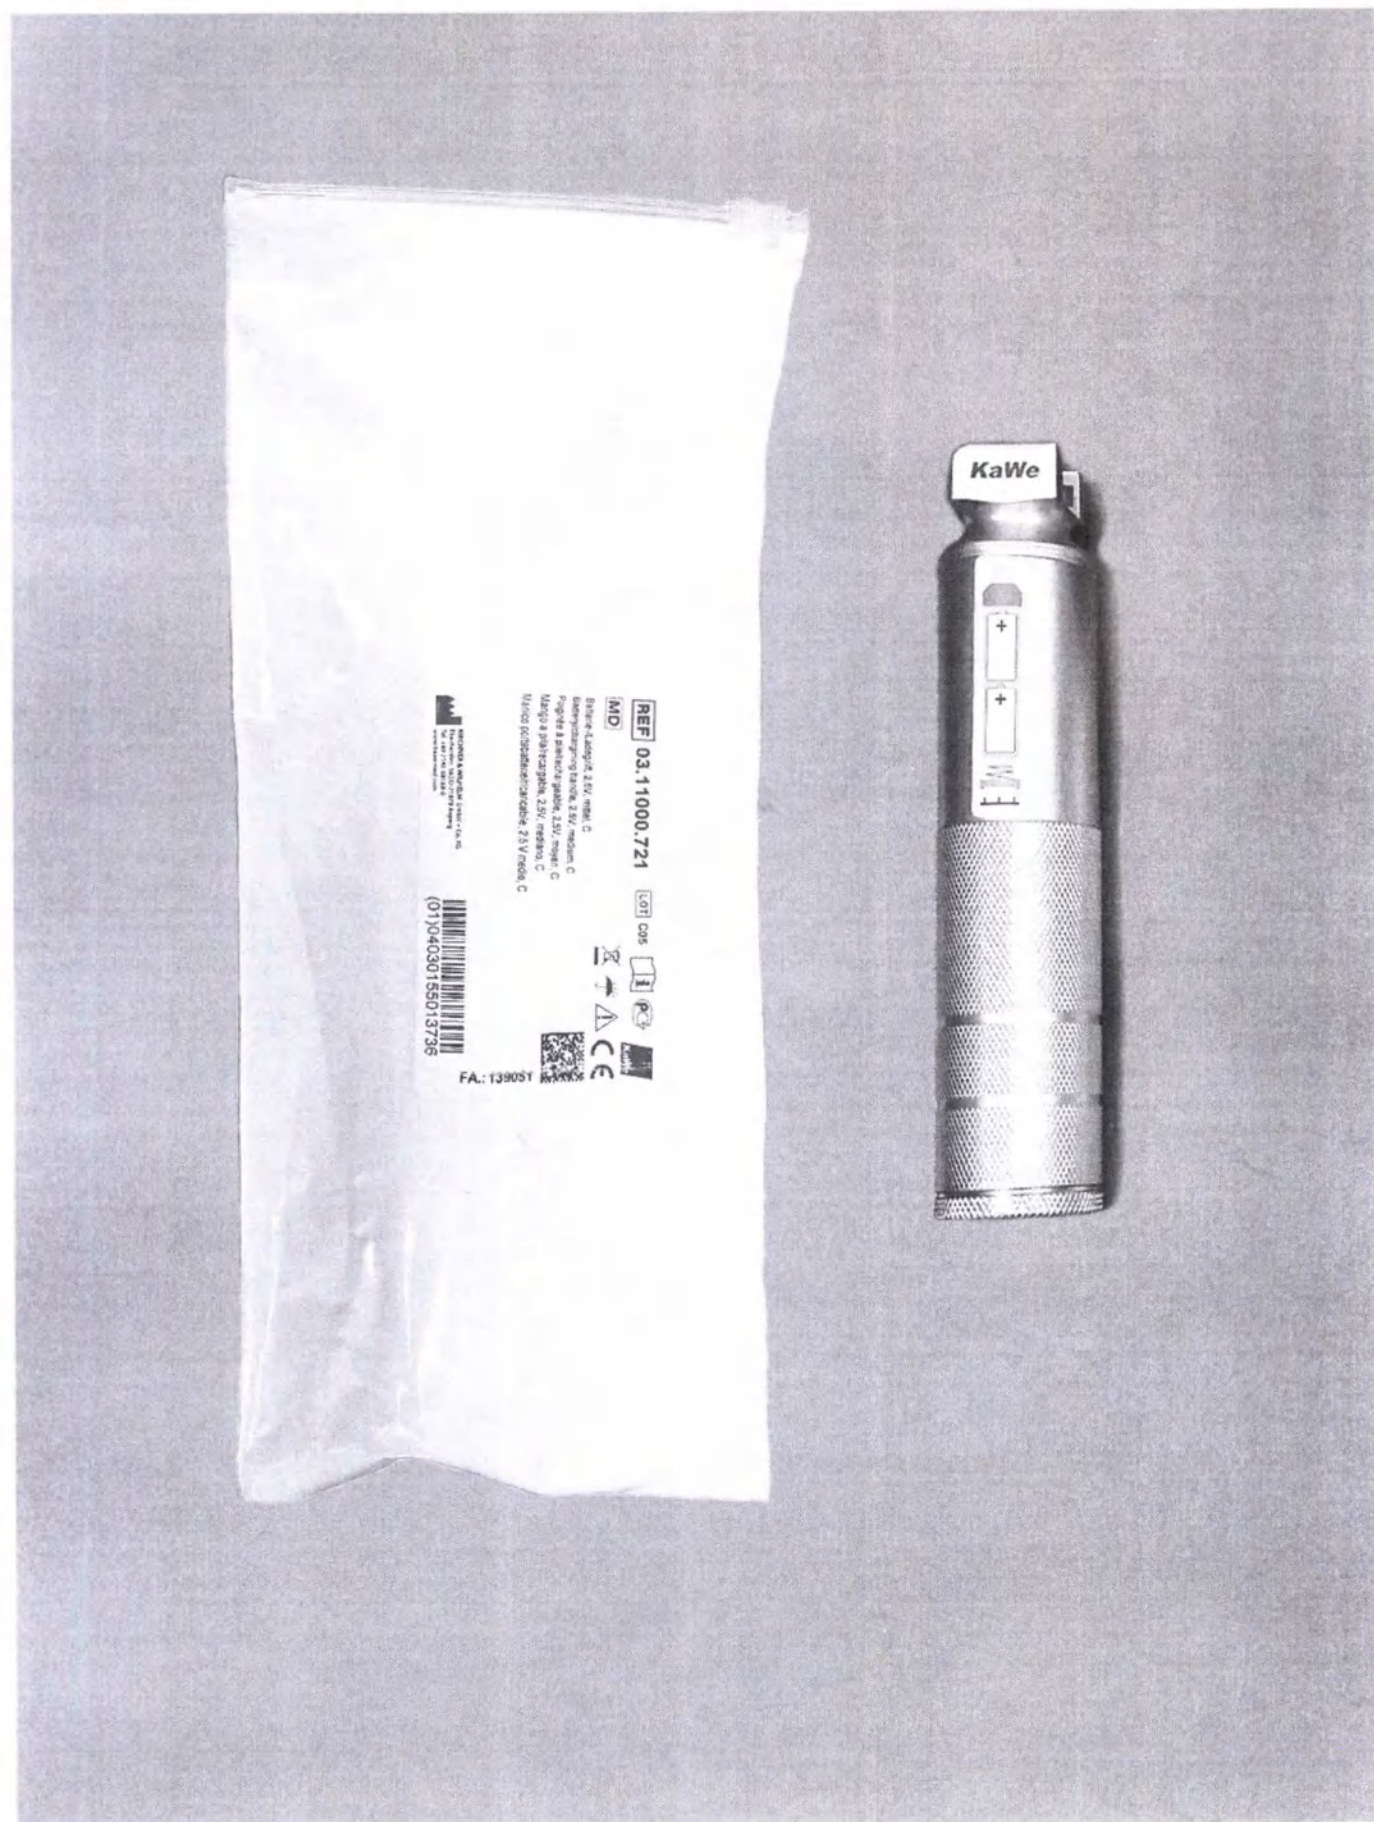


21. Рукоять стандартного освещения 2,5В большая, артикул 03.11000.731

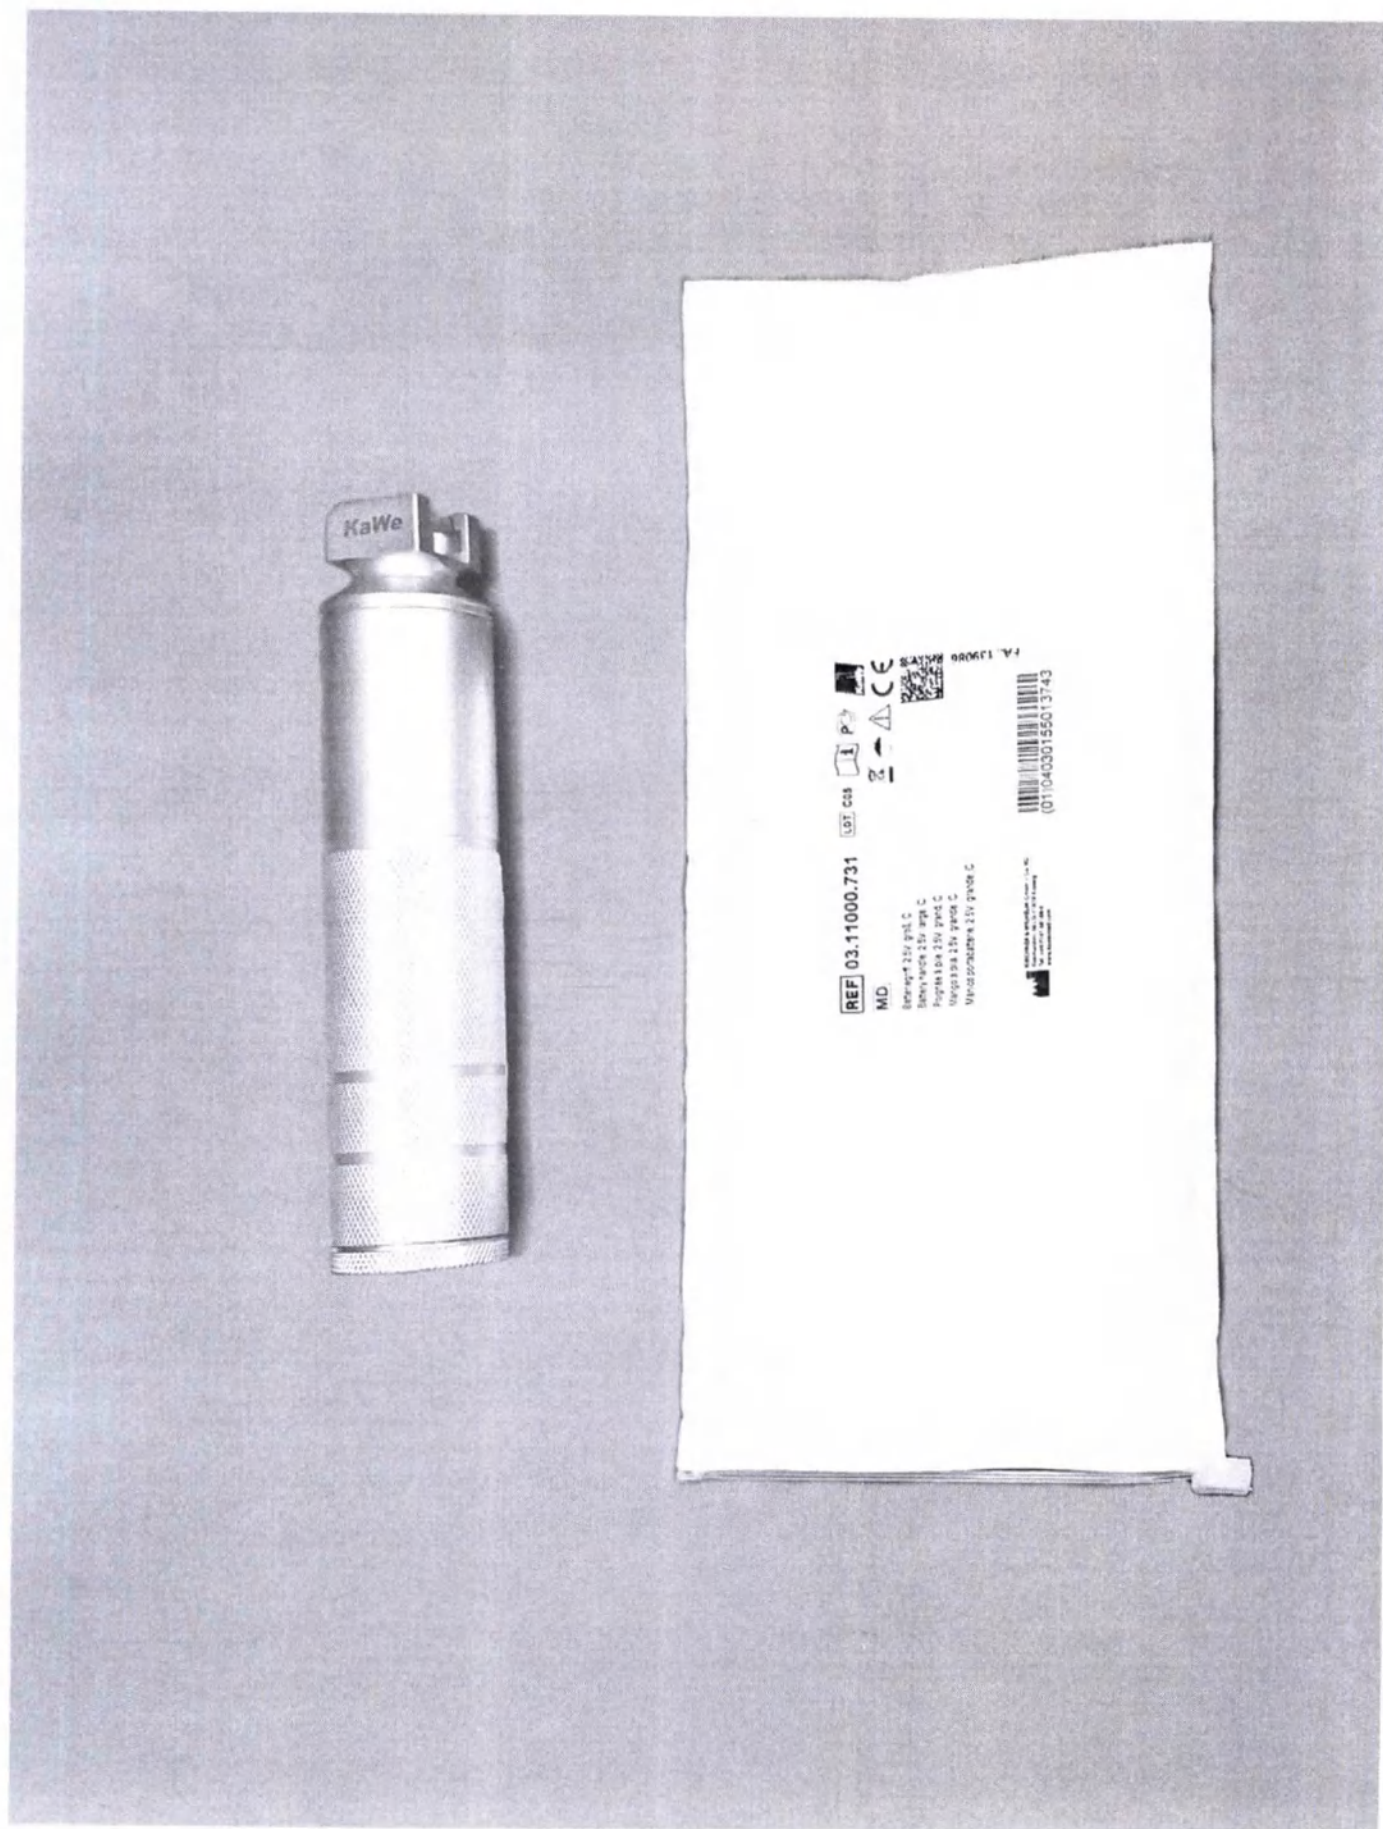

Принадлежности:

- Сменная лампа для ксеноновых рукоятей 2,5В, артикул 12.75141.003

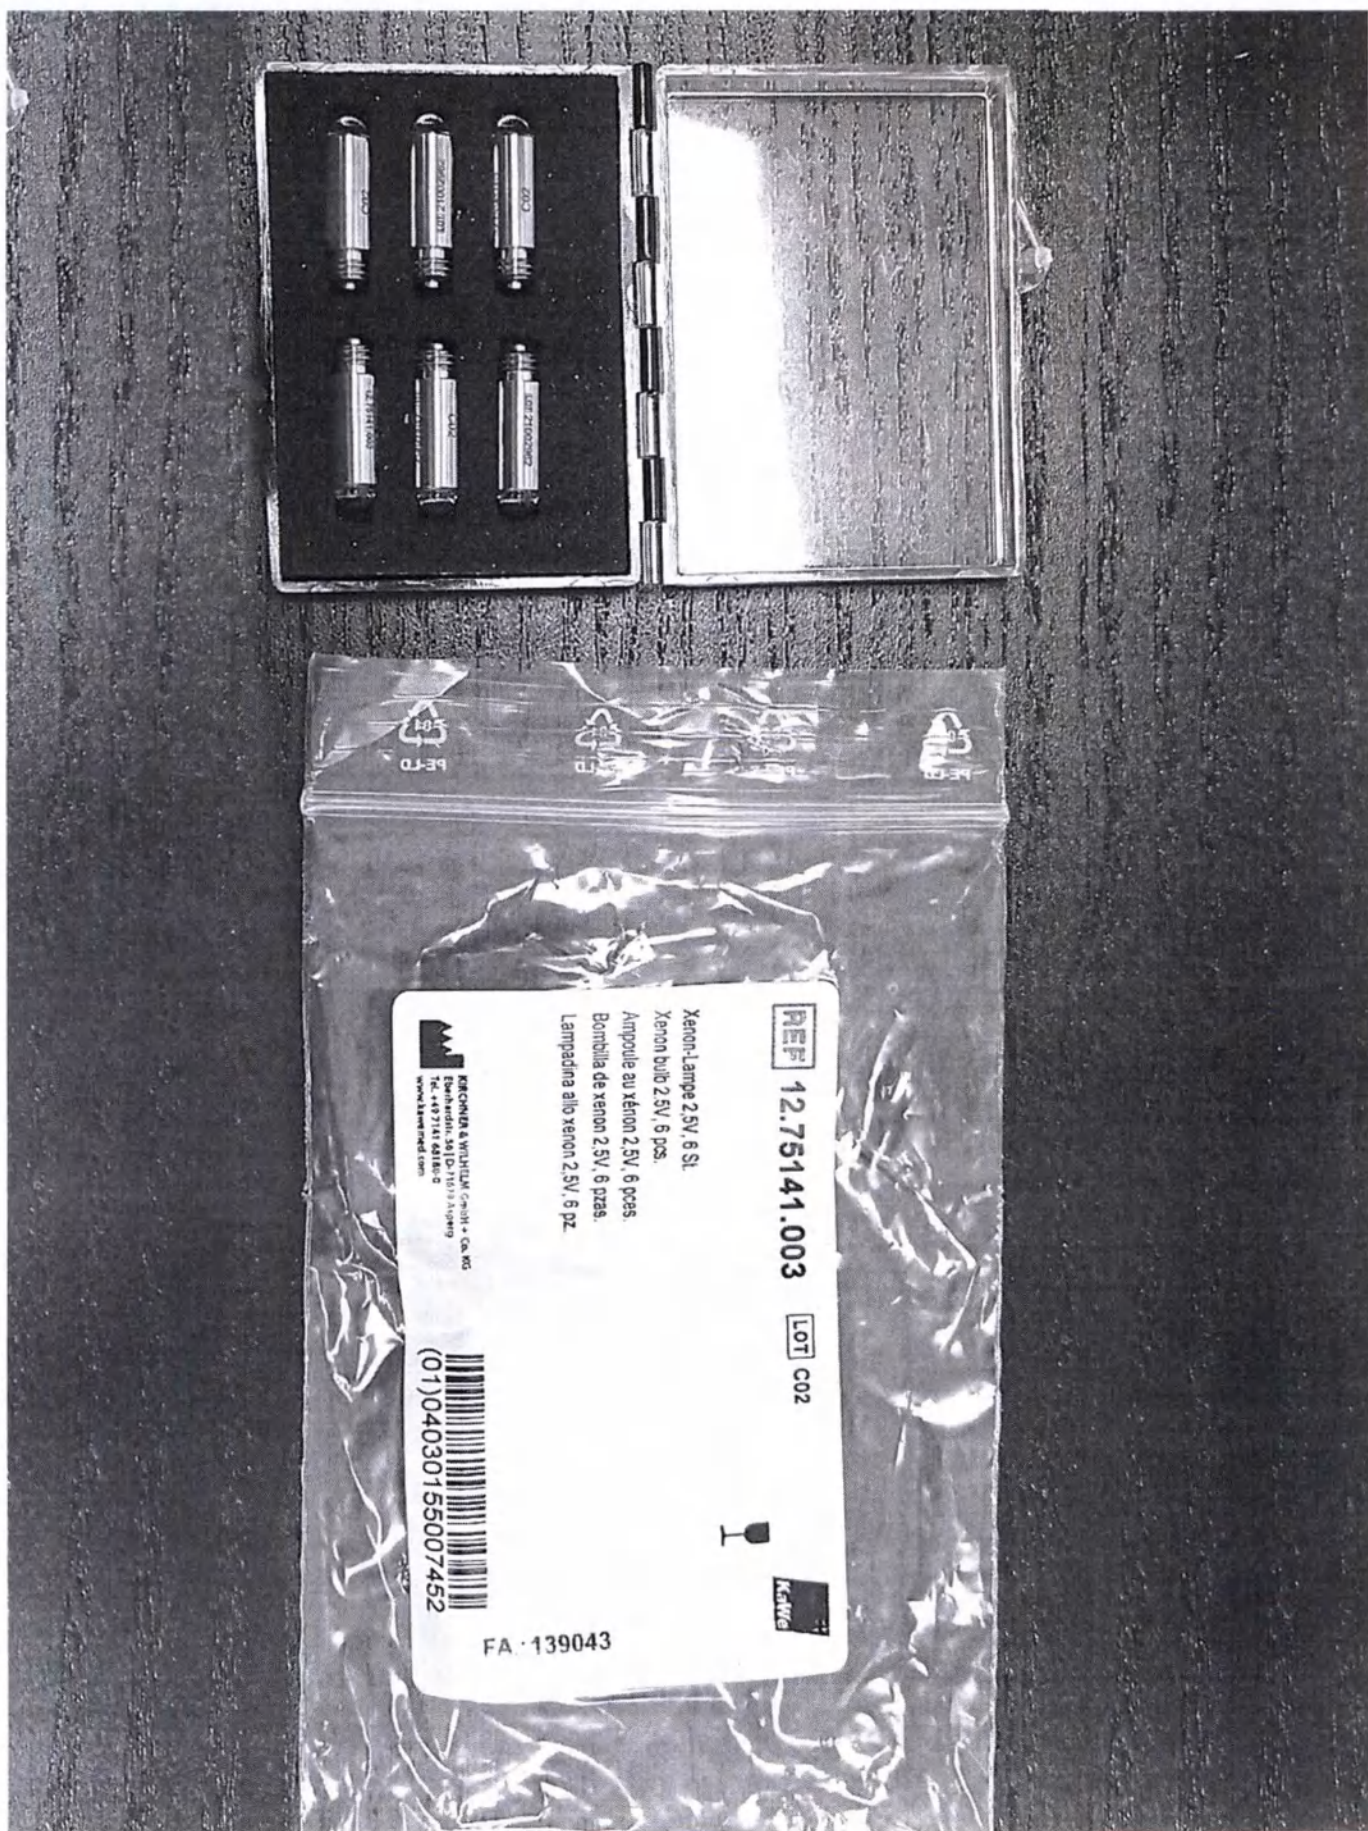


- Сменная лампа для ксеноновых рукоятей 3,5В, артикул 12.75244.013




- Сменная лампа для светодиодных рукоятей стандартной яркости 2,5В, артикул 12.75154.003





- Сменная лампа для светодиодных рукоятей повышенной яркости 2,5В, артикул 12.75151.003

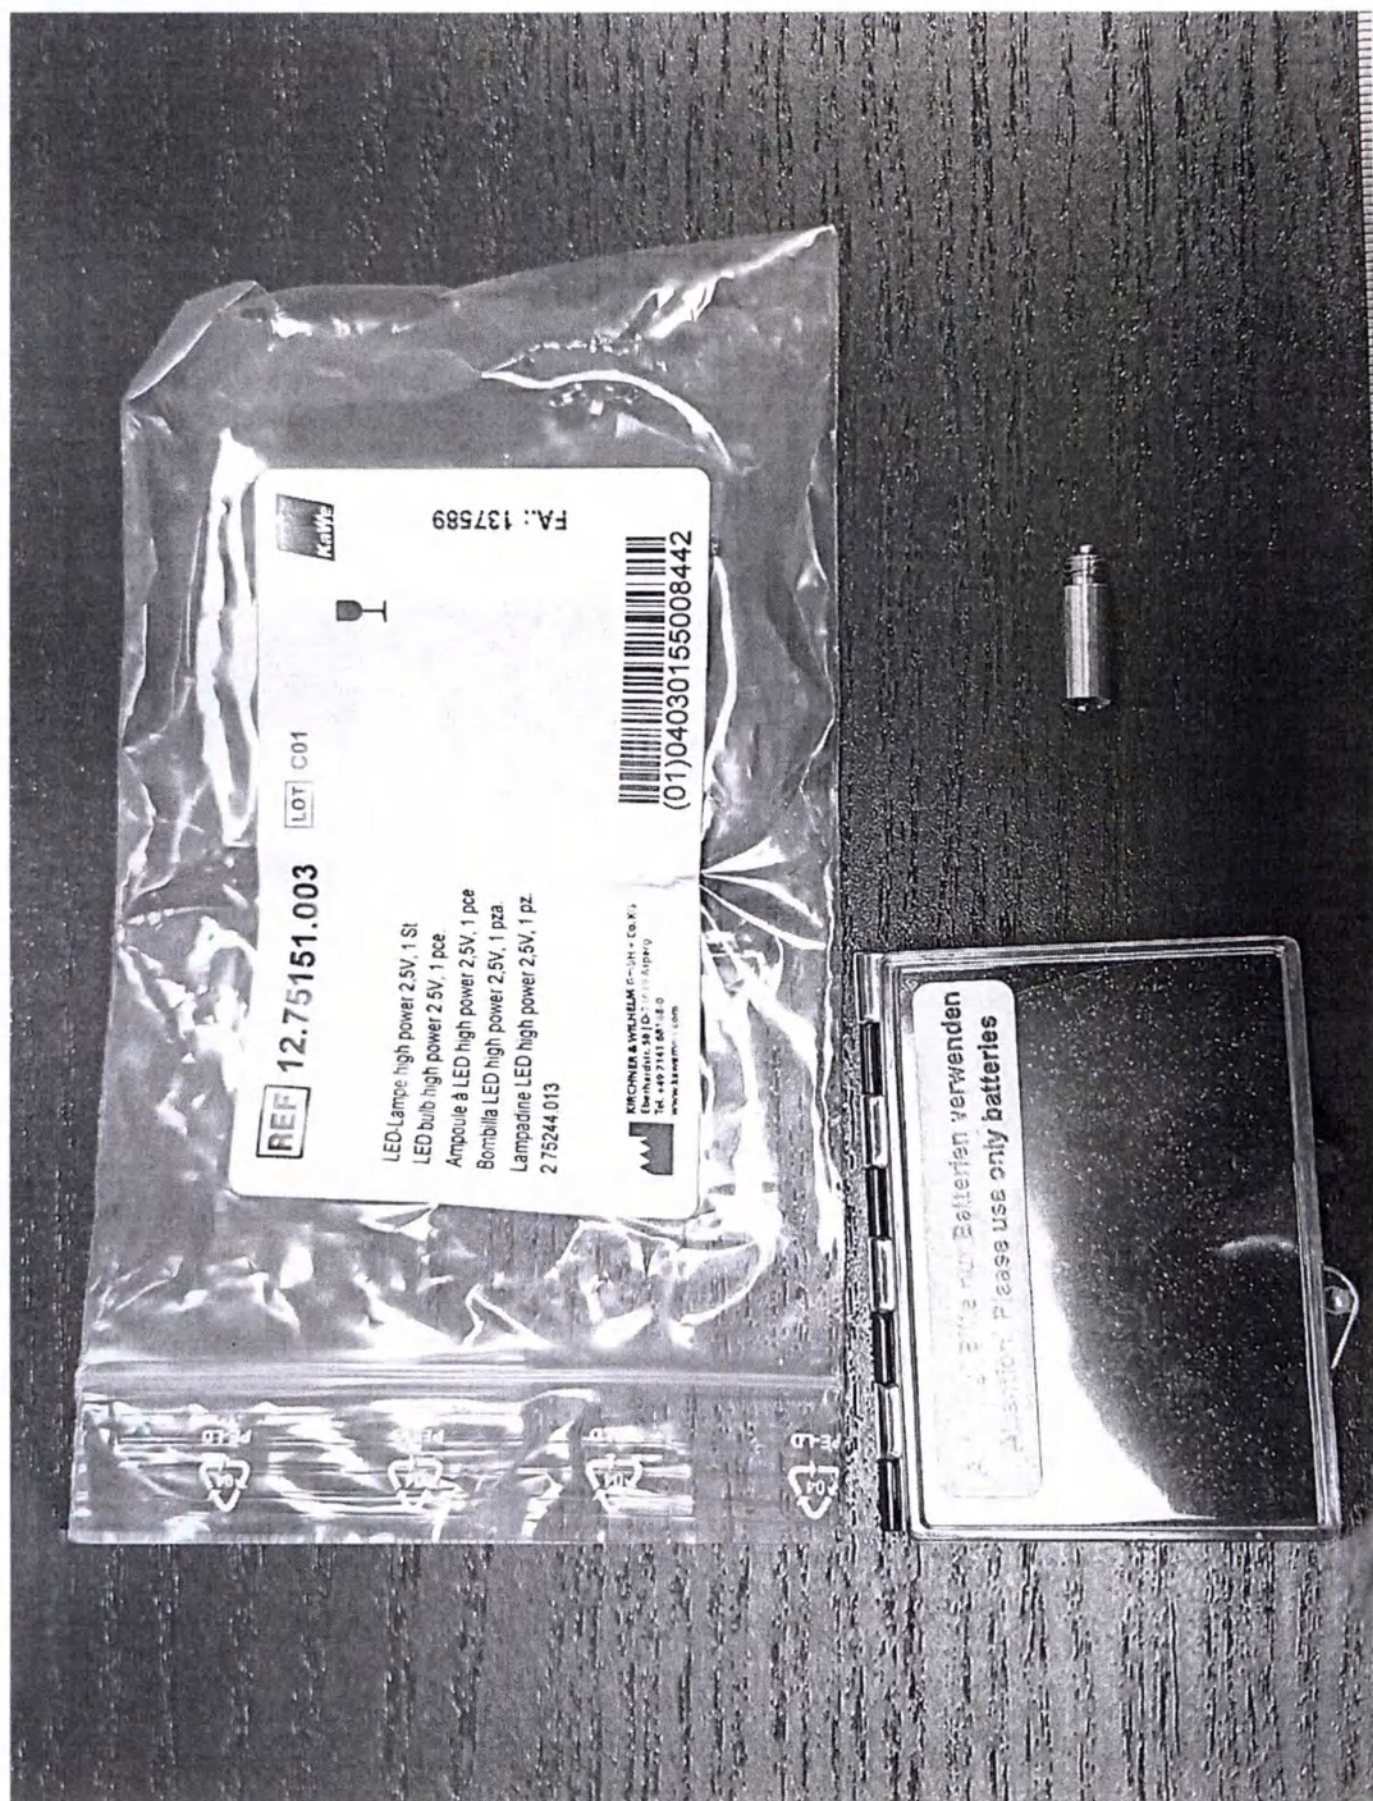


- Сменная лампа для светодиодных рукоятей повышенной яркости 3,5В, артикул 12.75251.003

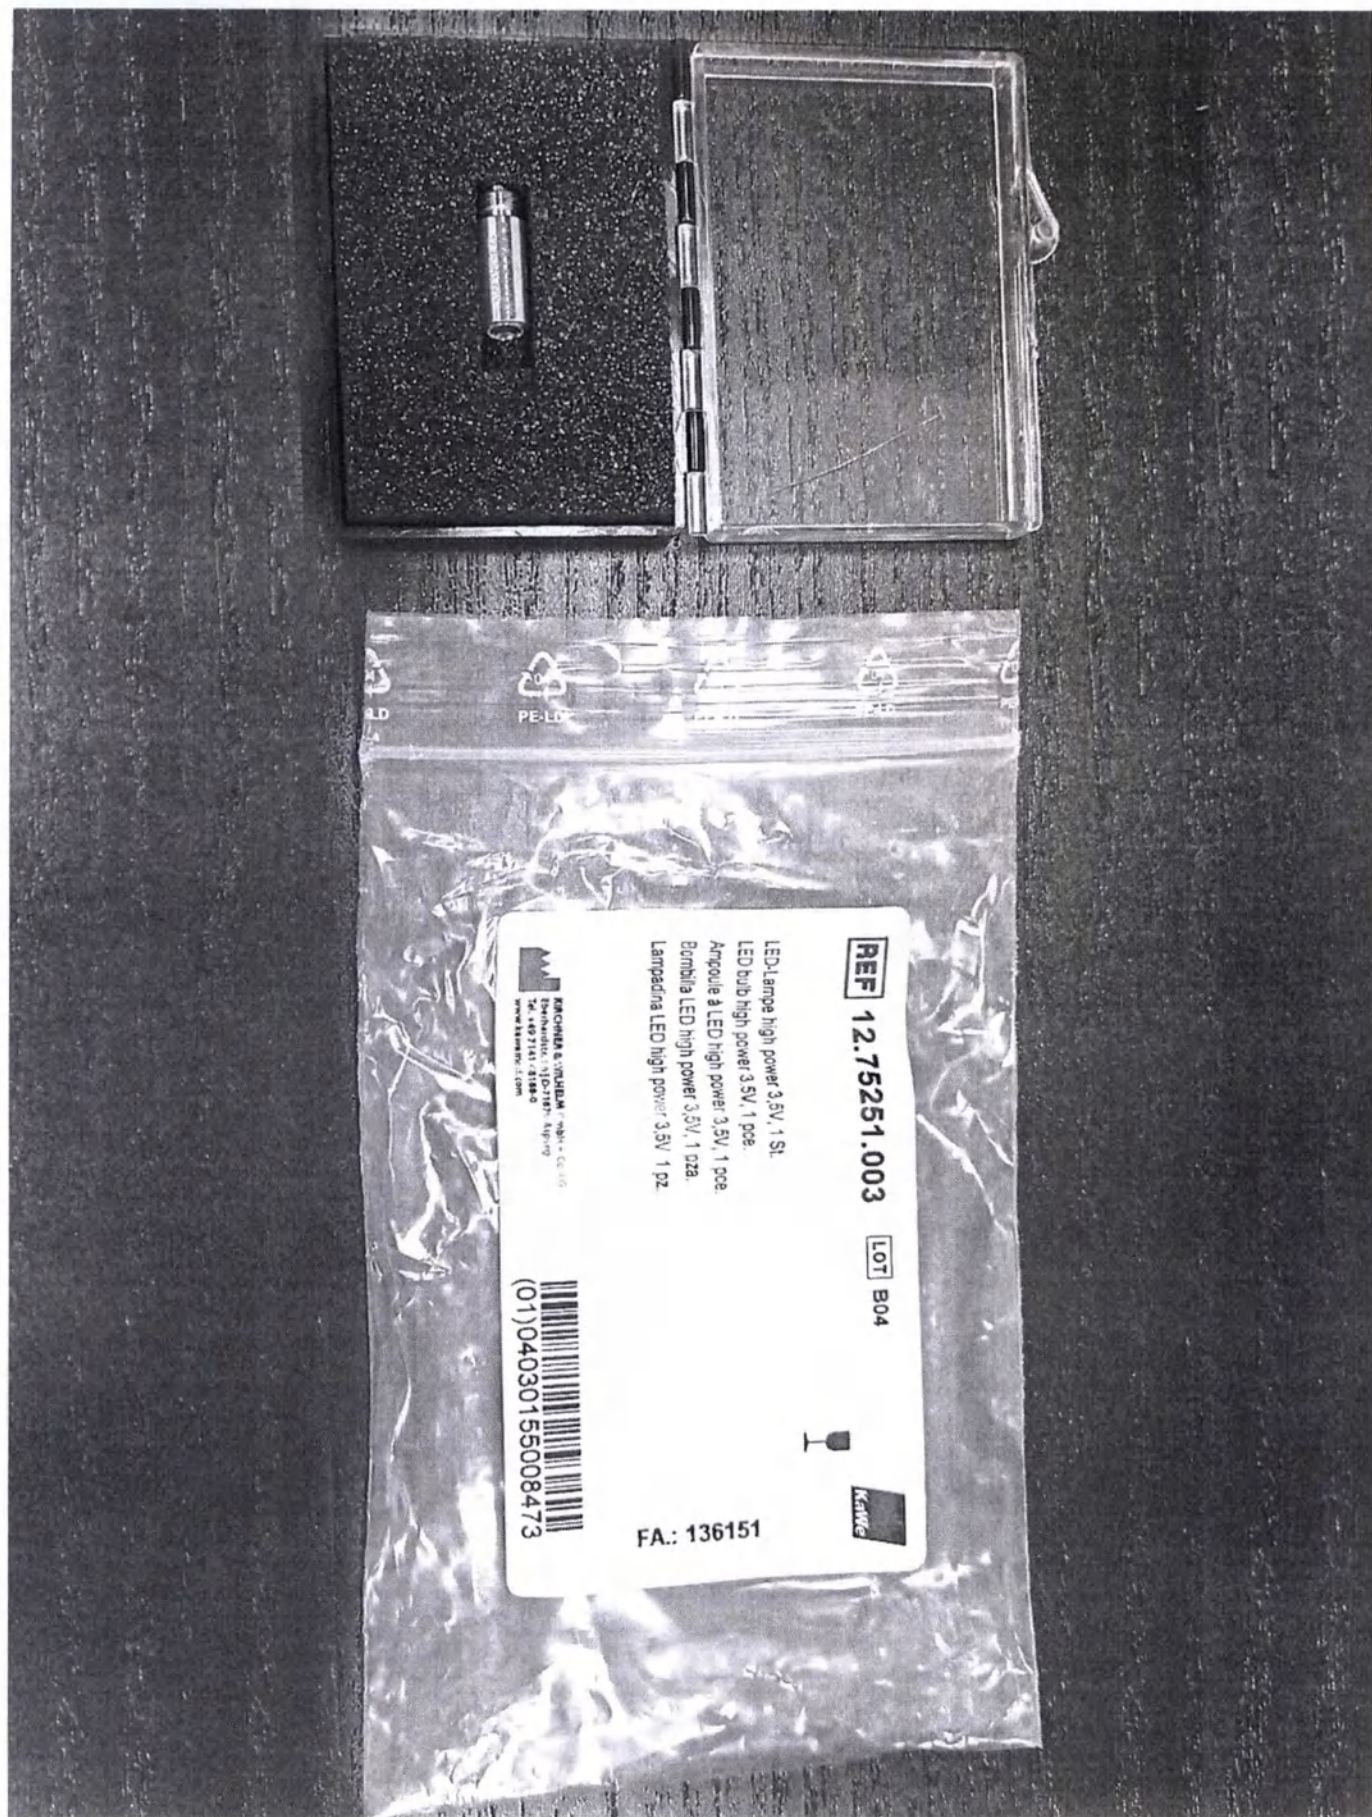

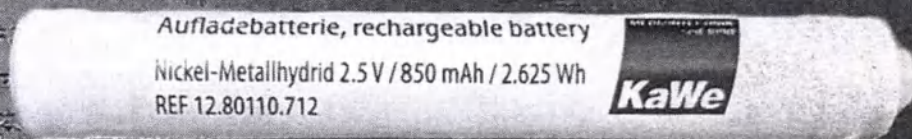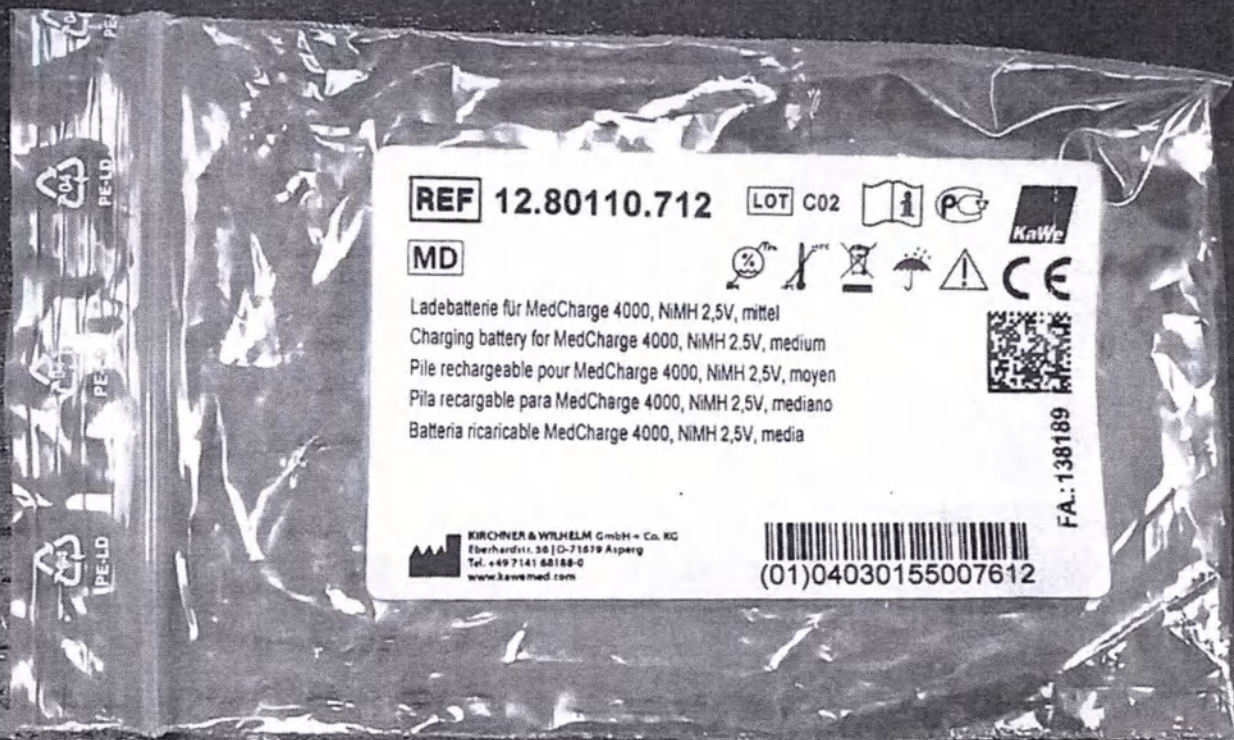


- Сменный аккумулятор для средней рукояти 2,5В, артикул 12.80110.722




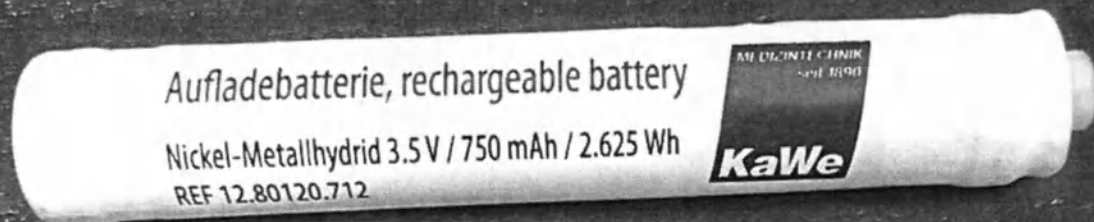


- Сменный аккумулятор для средней рукояти 3,5В, артикул 12.80220.722

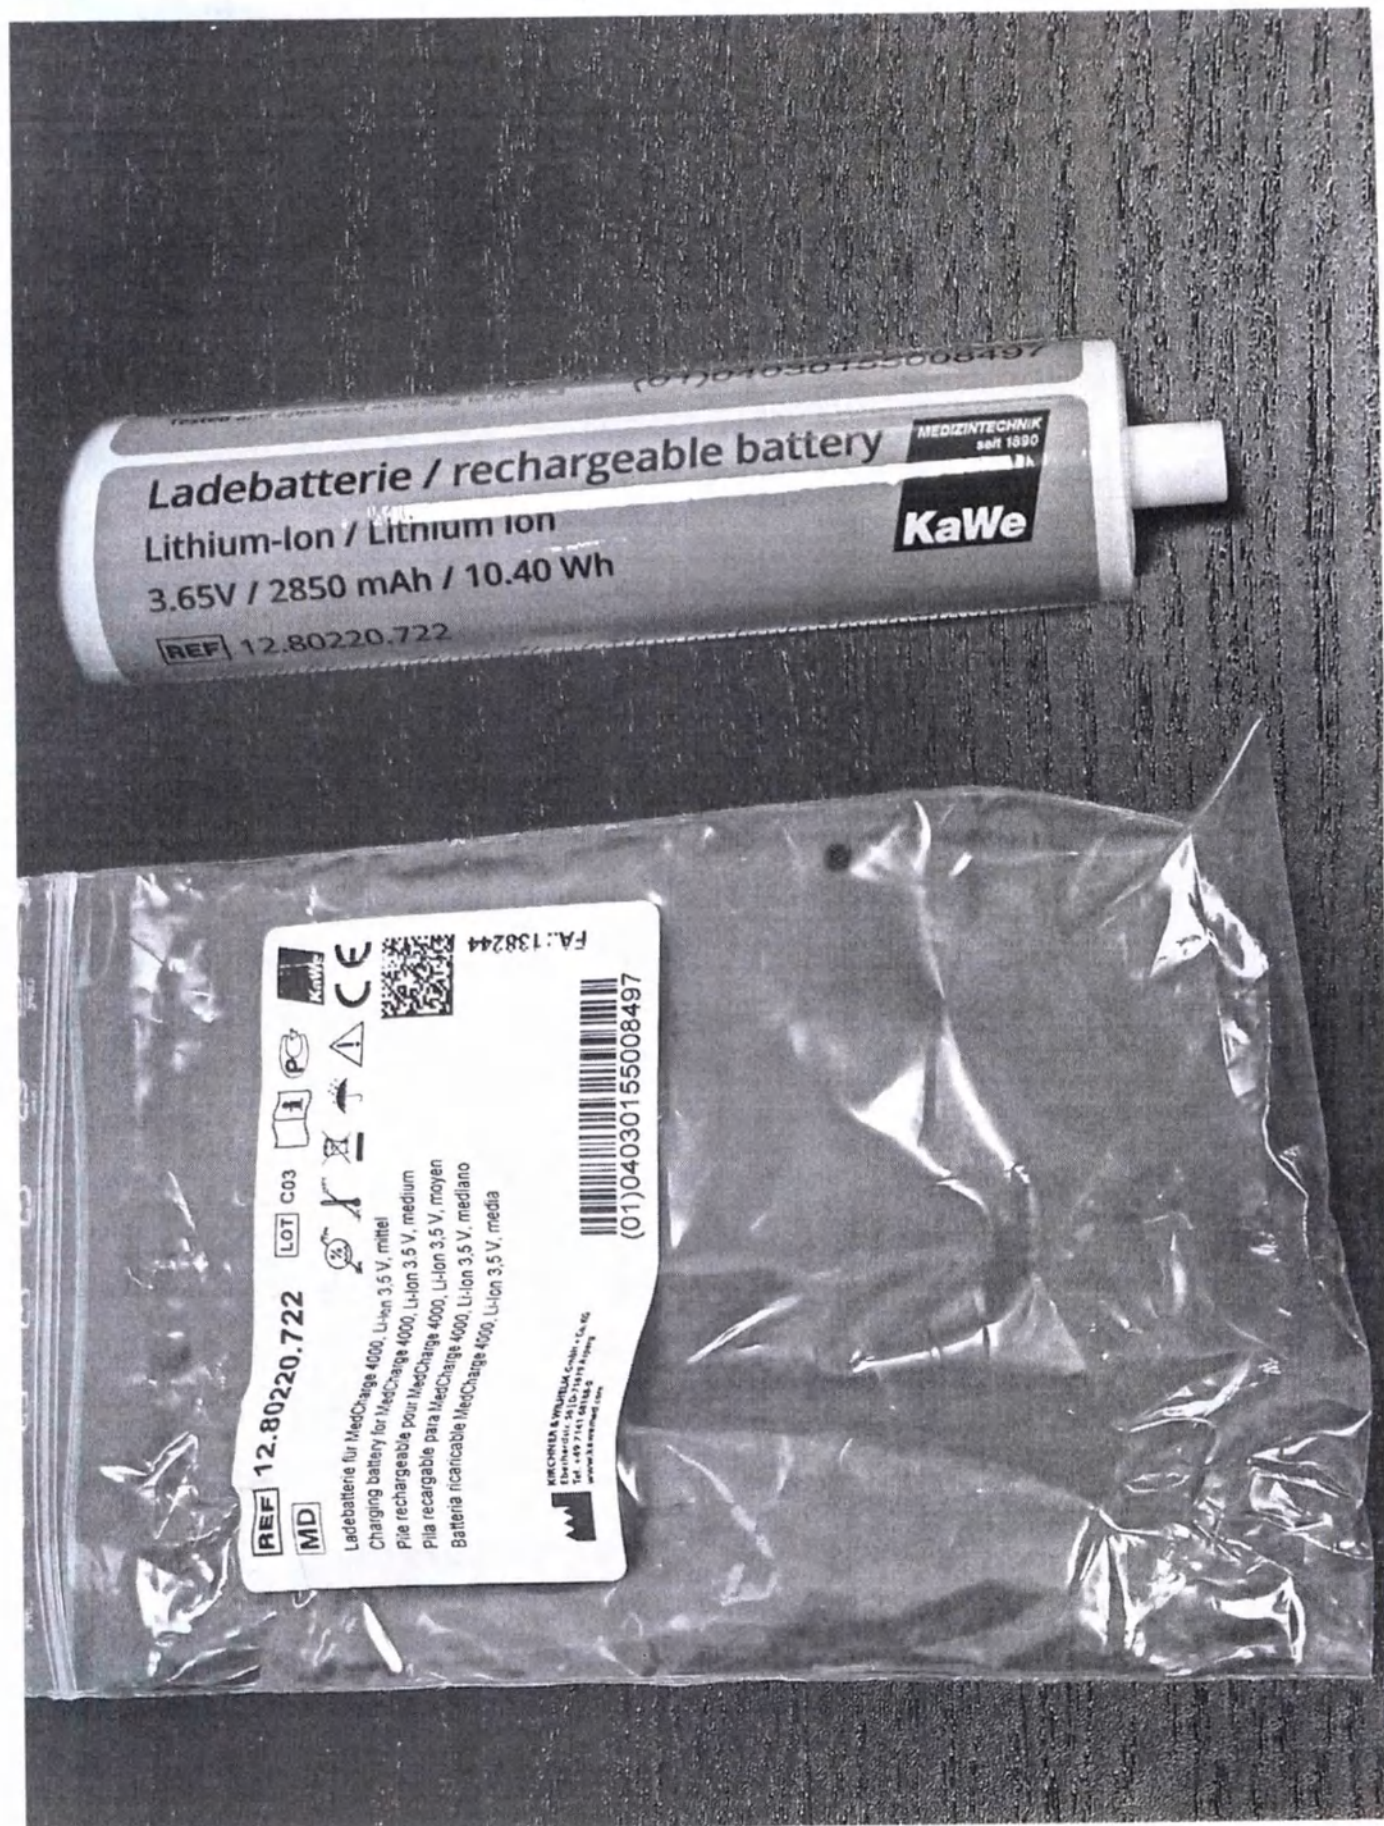


- Сменный аккумулятор для средней рукояти 3,5В со встроенной вилкой, артикул 12.80120.742

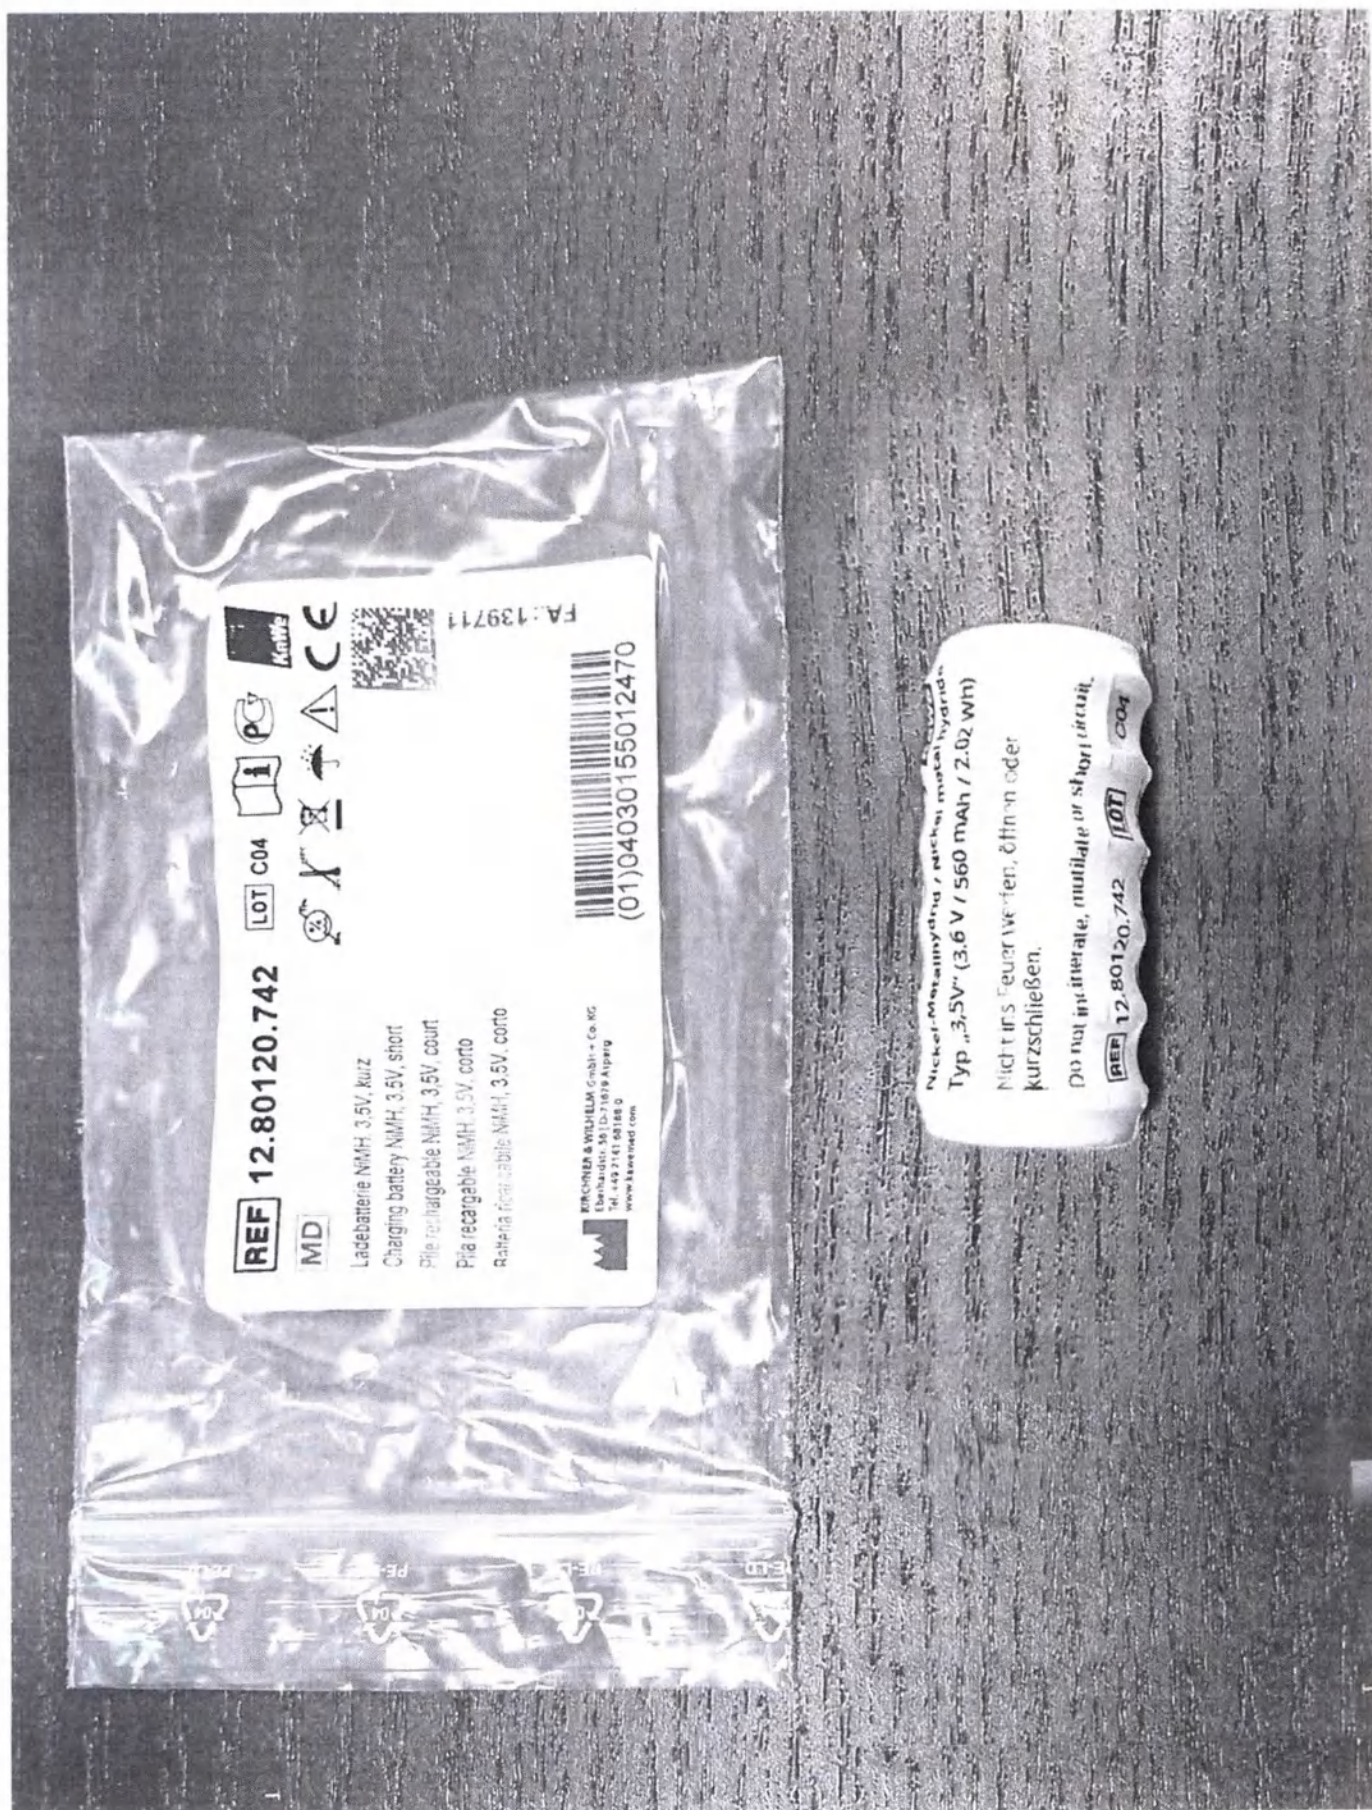


- Зарядное устройство MedCharge4000 для рукоятей, артикул 12.80005.002

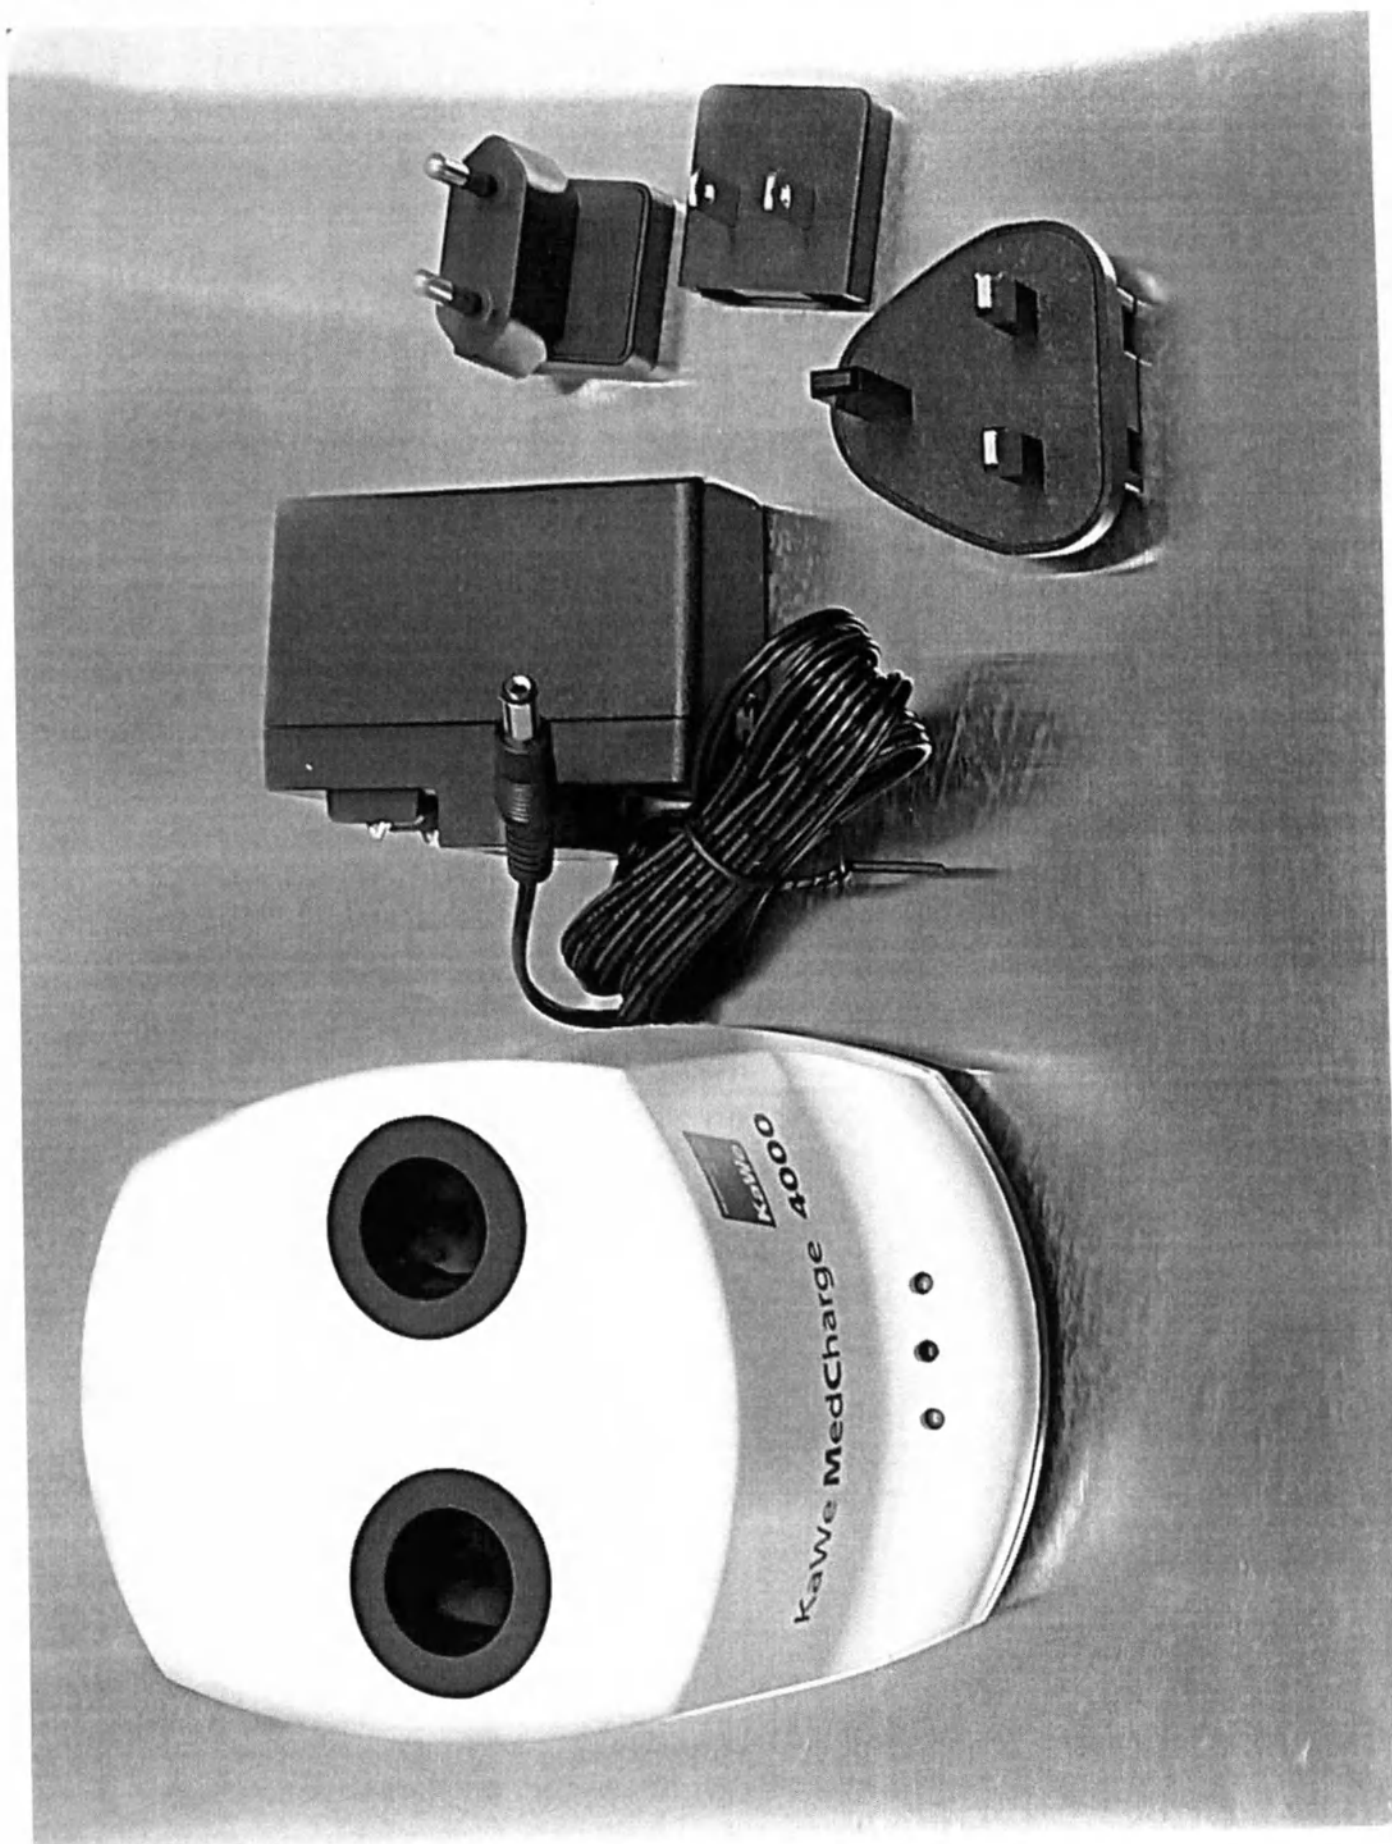


- Кейс для ларингоскопа для двух клинков и рукояти, артикул 03.90051.261

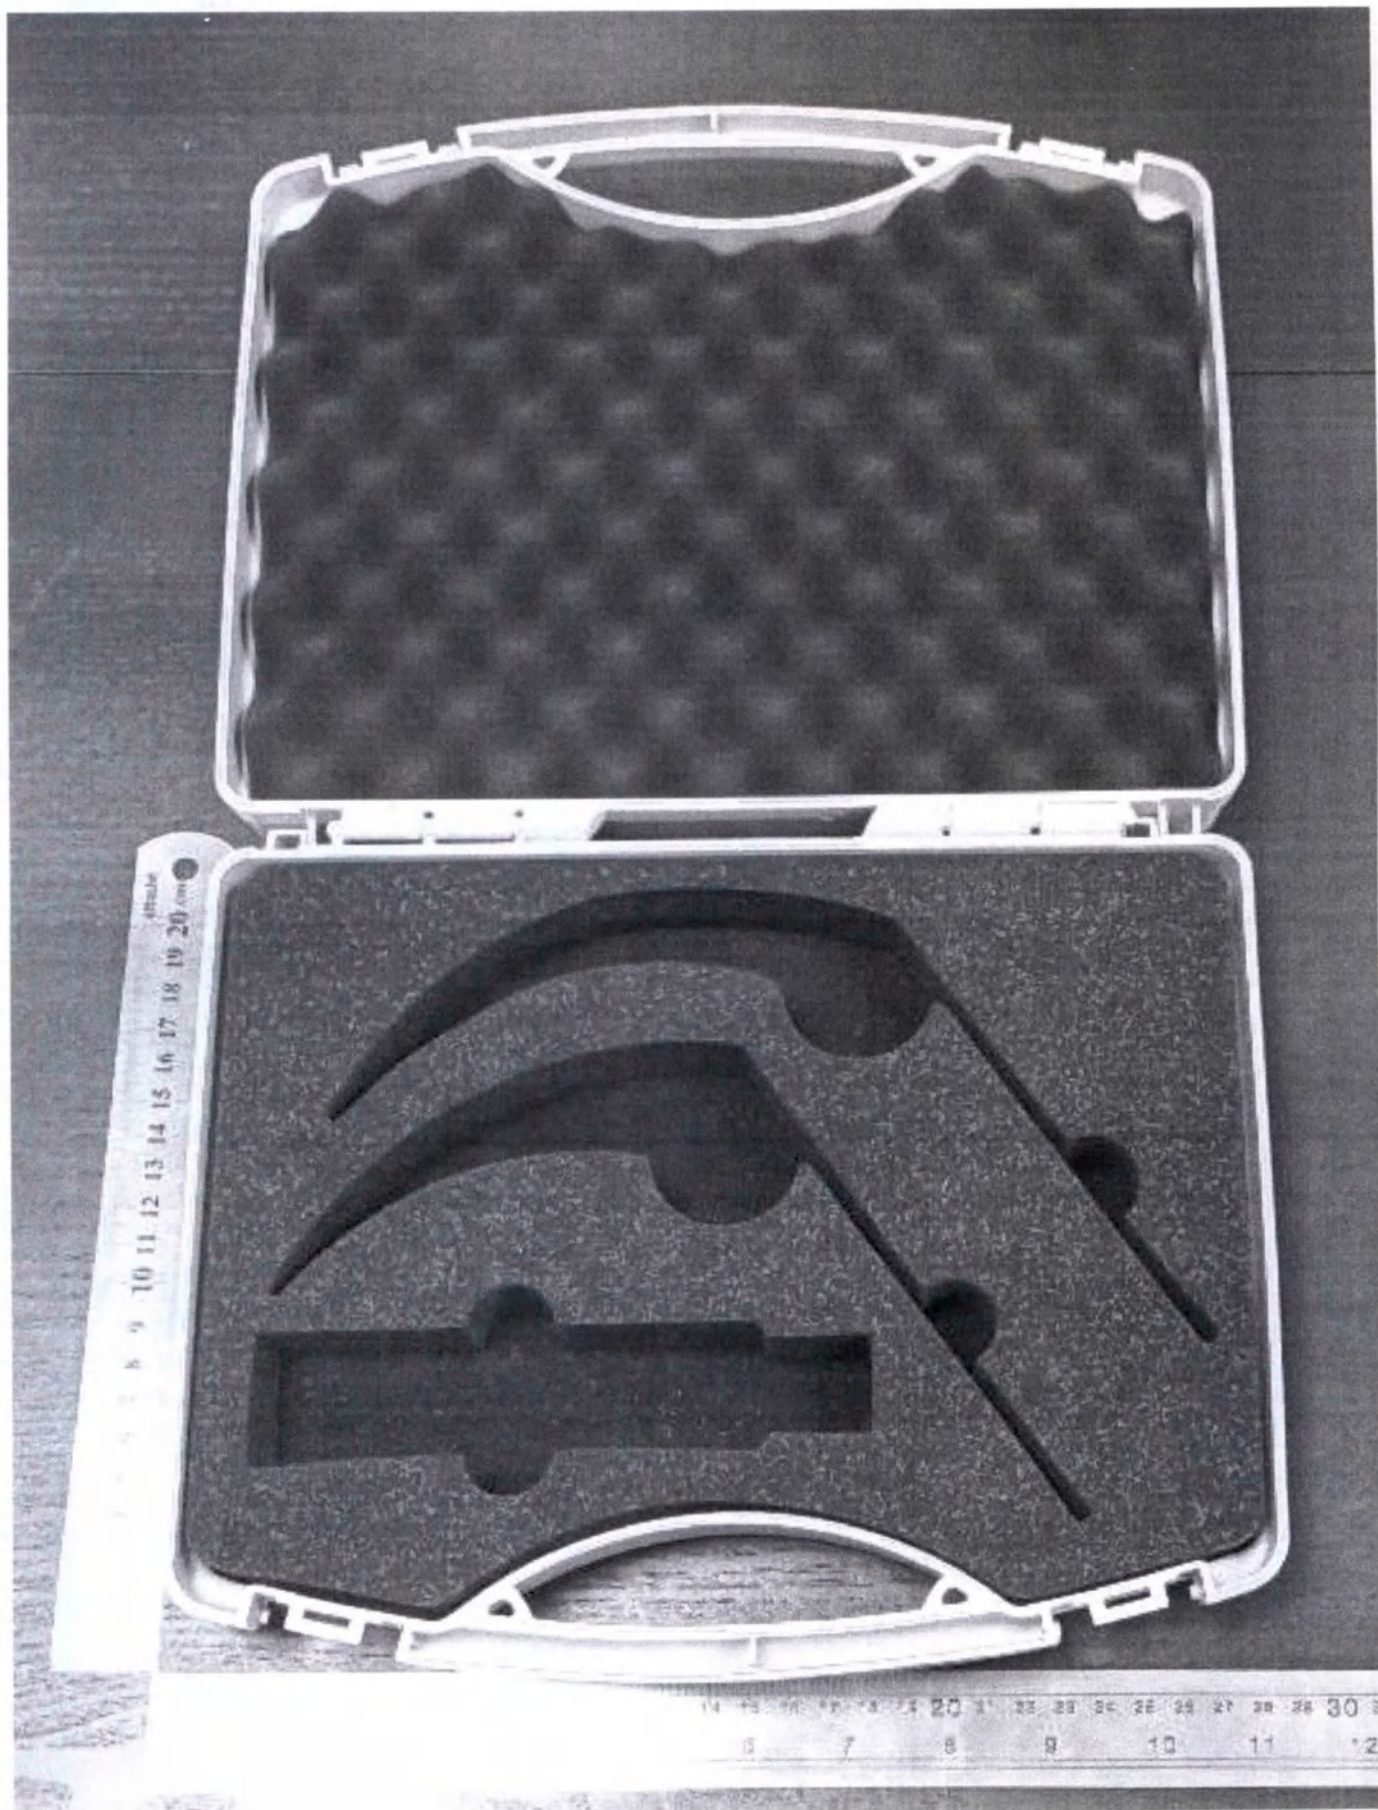

- Кейс для ларингоскопа для трех клинков и рукояти, артикул 03.90001.261

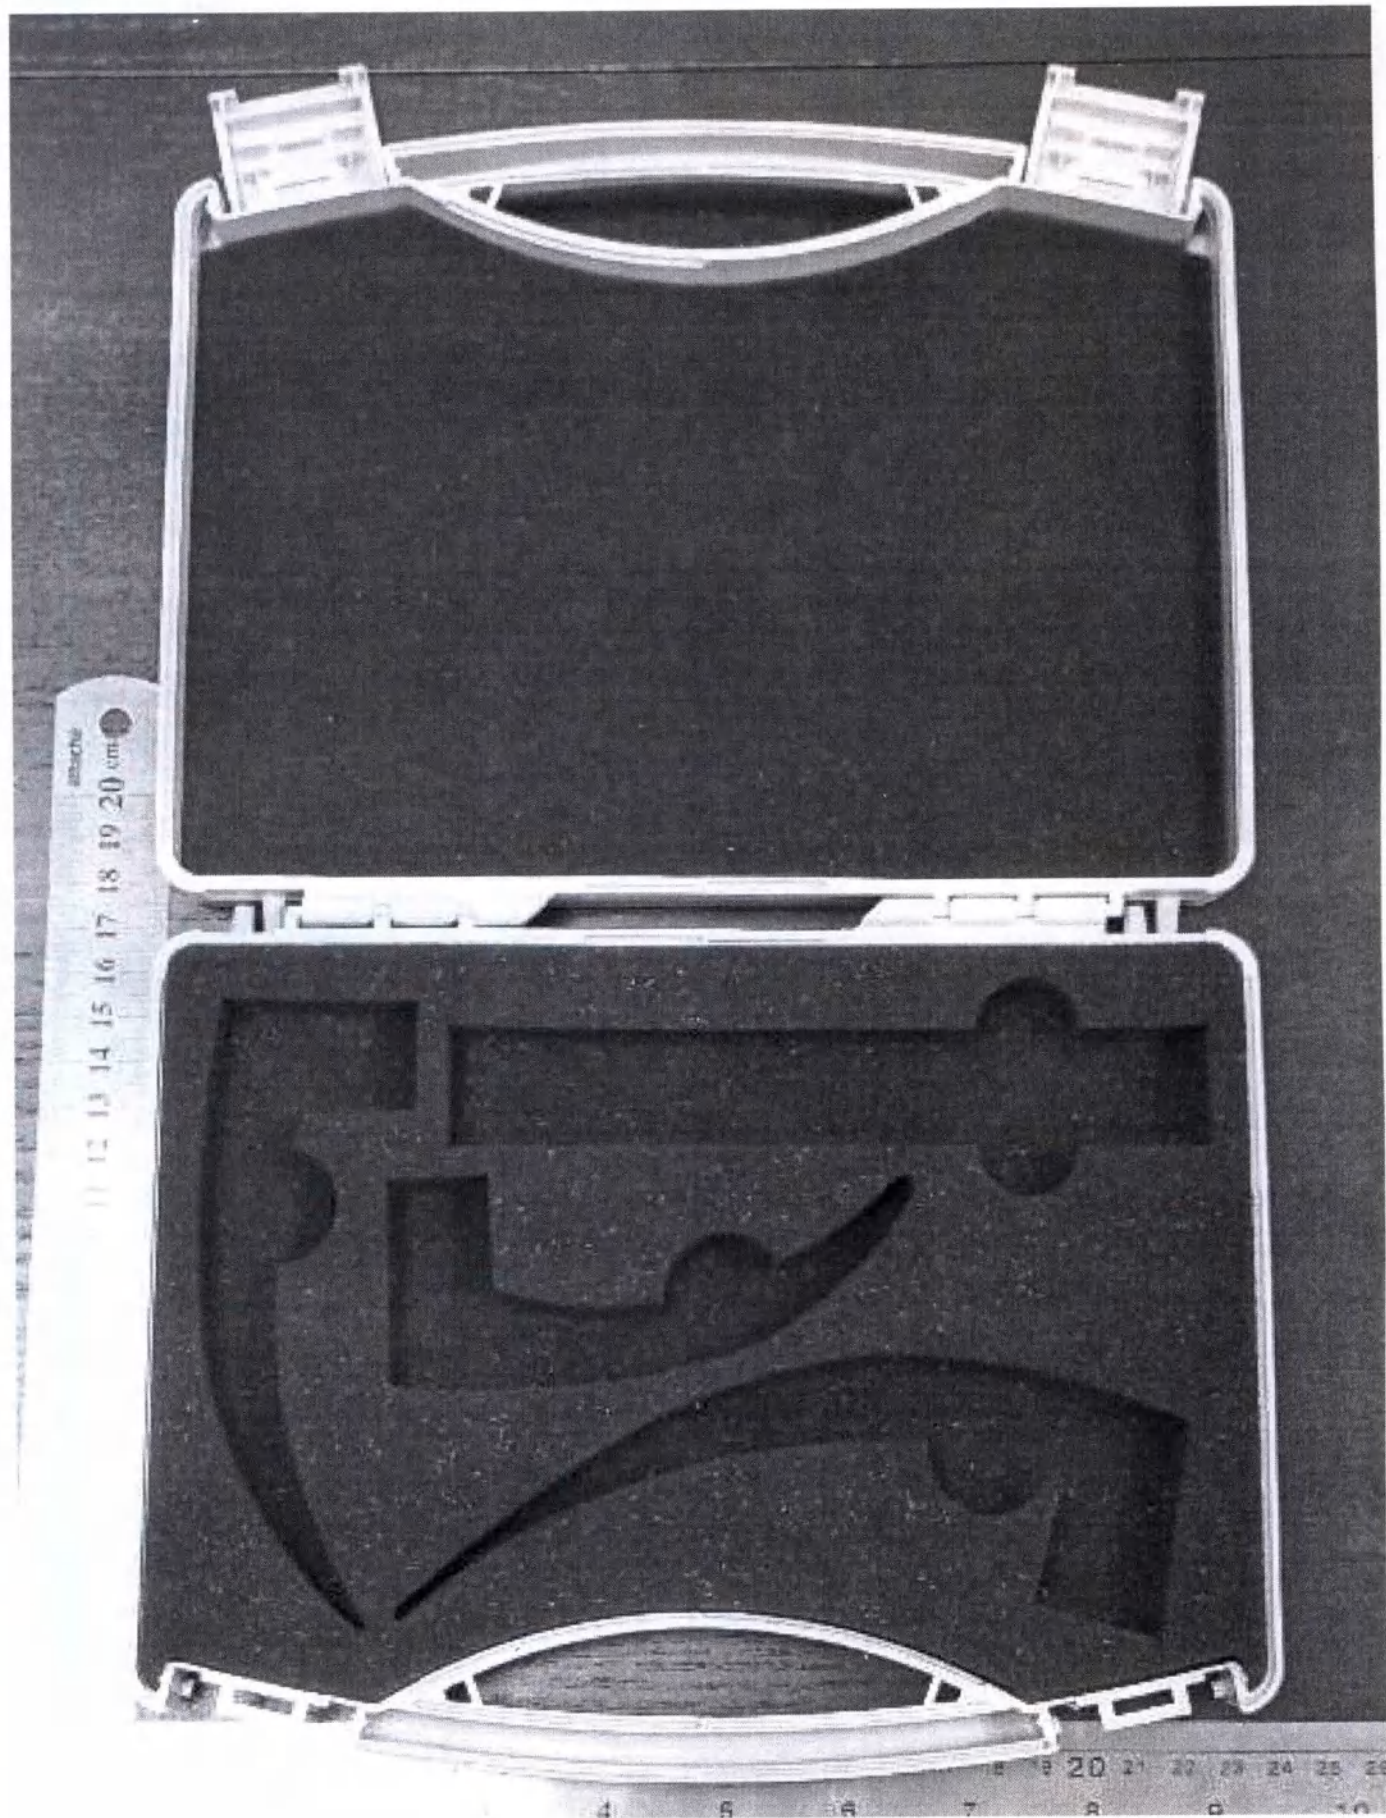

- Кейс для ларингоскопа для пяти клинков и рукояти, артикул 03.90002.261

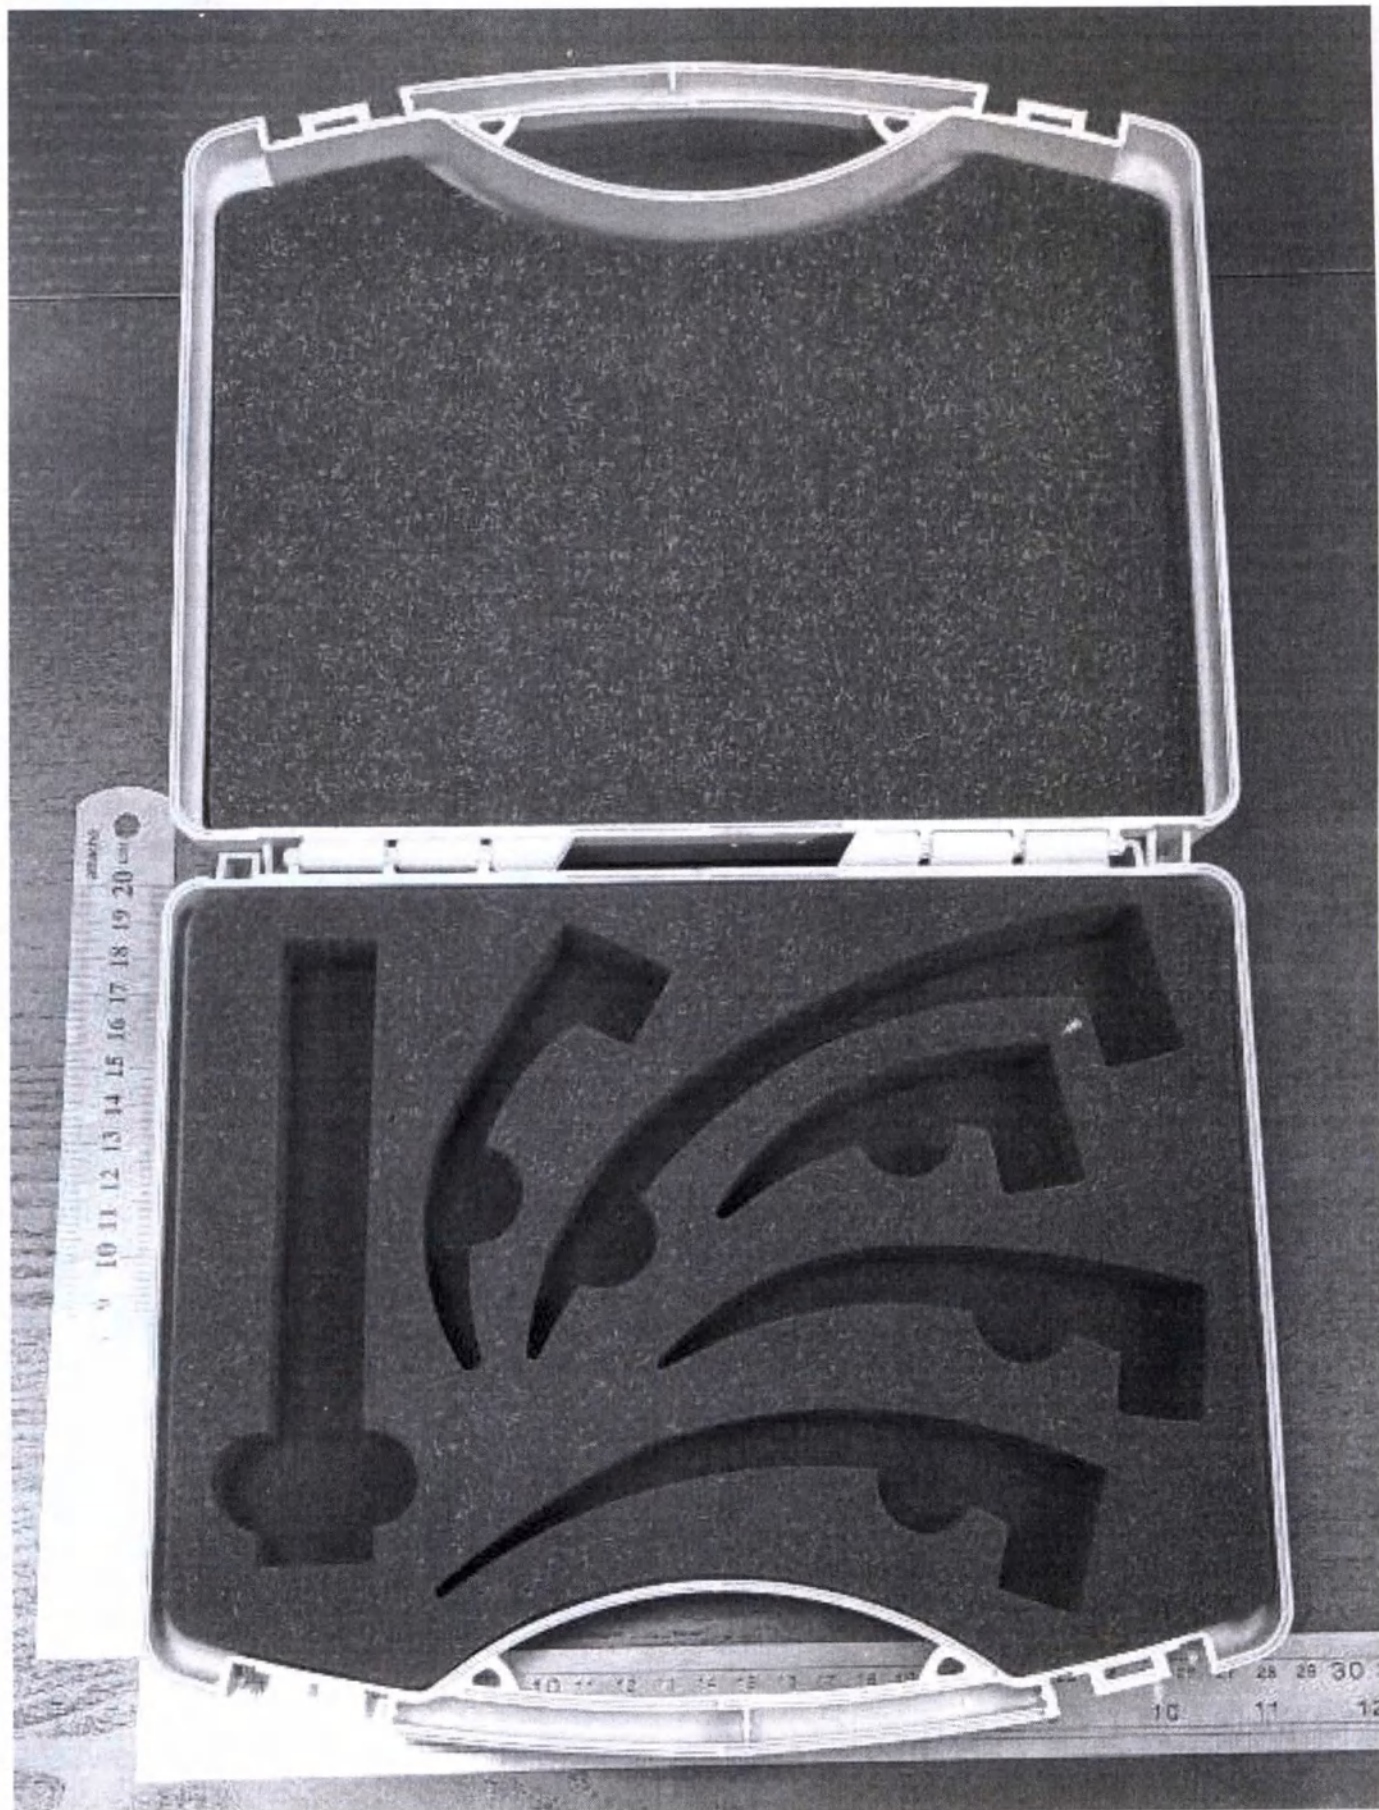

- Кейс для ларингоскопа для шести клинков и рукояти, артикул 03.90006.261




- Кейс для ларингоскопа для семи клинков и рукояти, артикул 03.90004.261





- Сумочка для ларингоскопа для четырех клинков и рукояти, артикул 03.90003.001

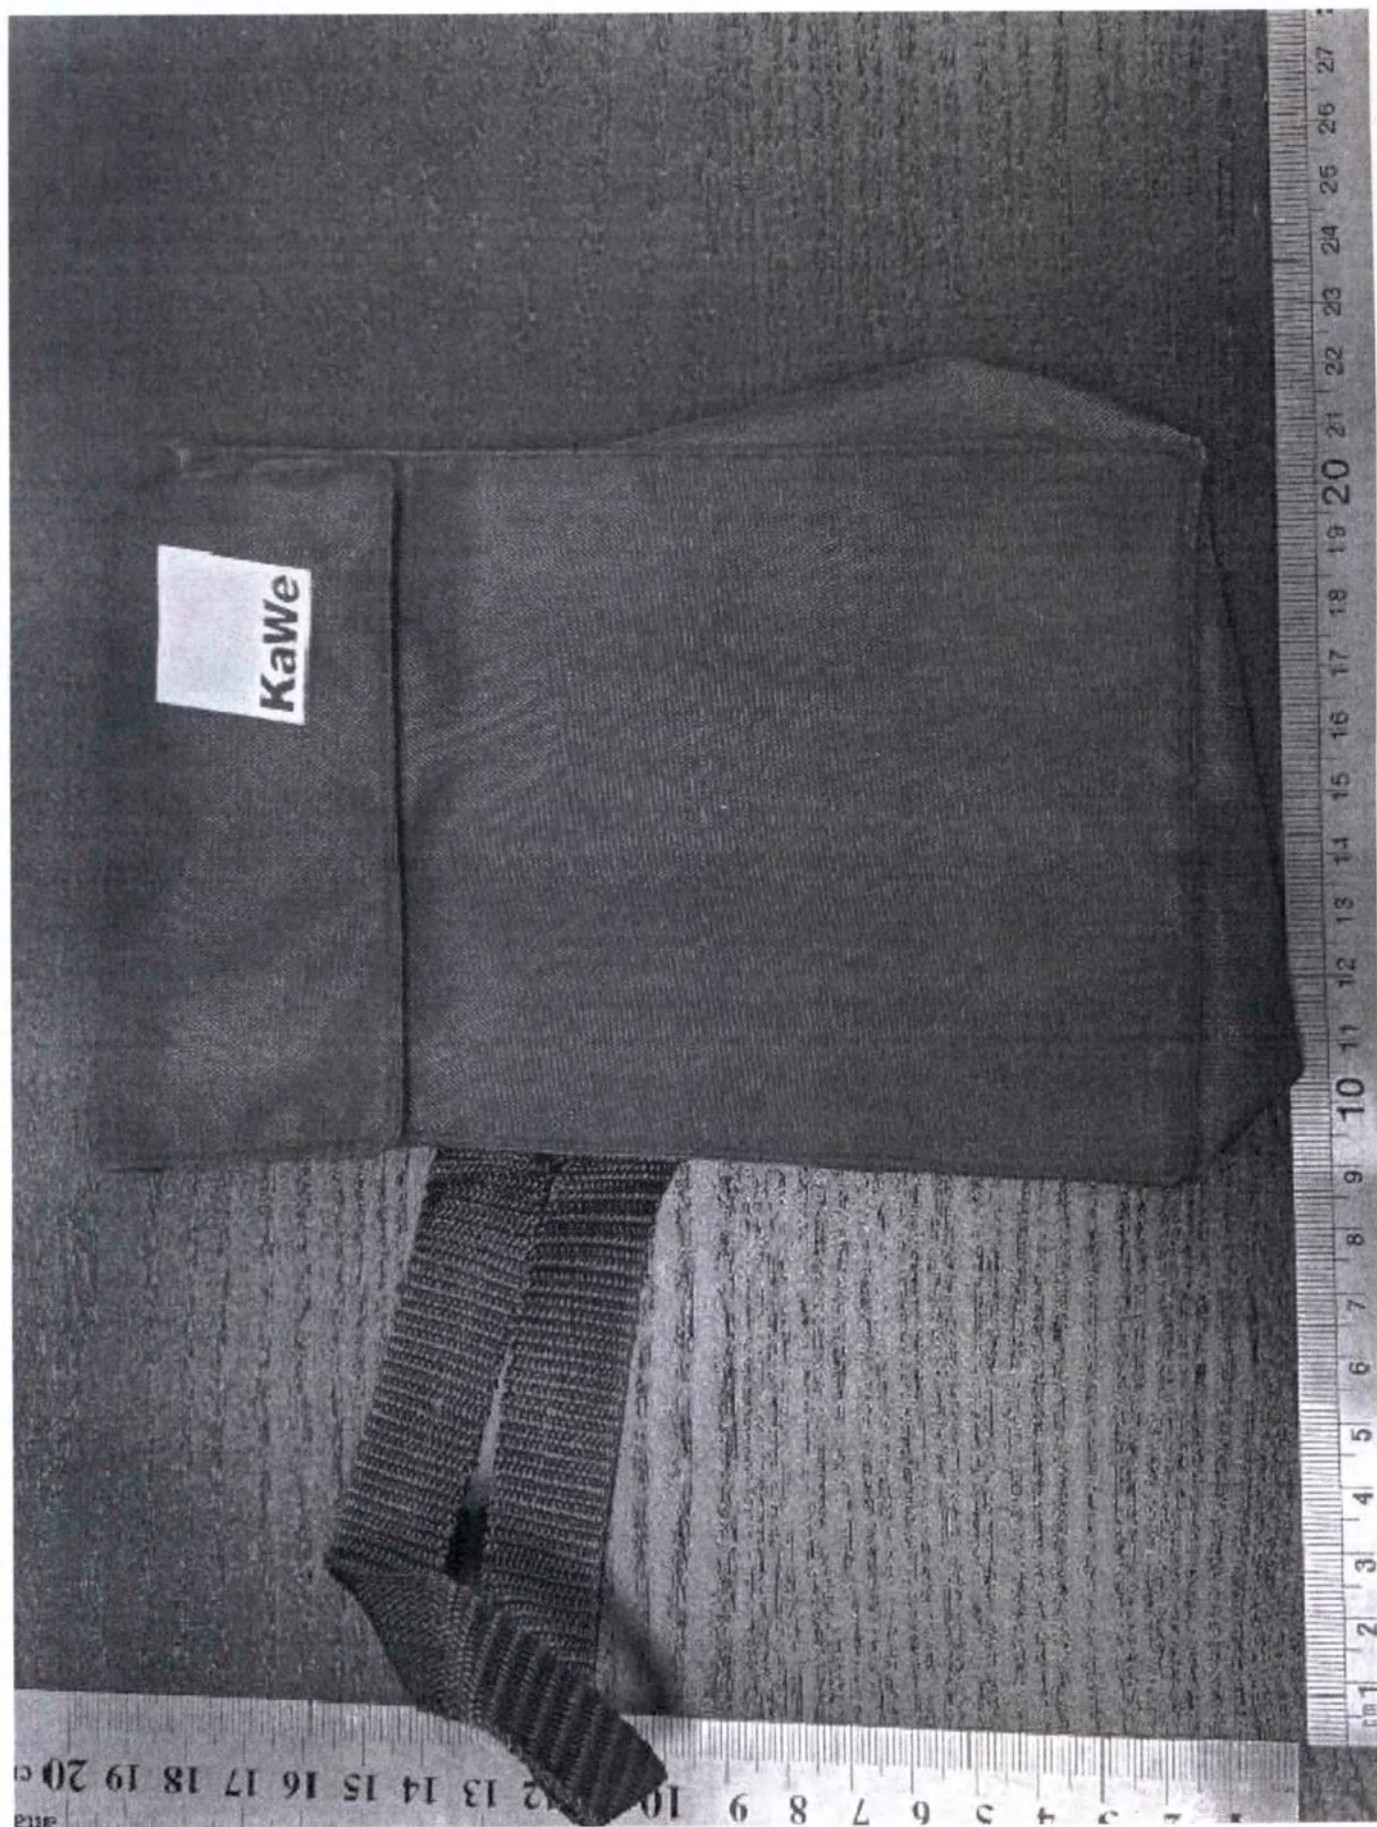

Внешний вид транспортной упаковки (для всех вариантов исполнения)



Рукоять ларингоскопа KAWE
Рукоять фиброоптическая с ксеноновым
освещением 2,5В большая



XX шт.

Регистрационное удостоверение РУ № _____ от _____



КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмБХ + Ко. КГ,
Эбенхардштр. 56, 71679 Асперг, Германия
Тел.: +49 (0)7141-68-188-0, Факс: +49 (0)7141-68-188-11
t-mail: info@kawemed.de, www.kawemed.com



2021-09

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
по вопросам полного обращения медицинских изделий:
ООО «ОЛИМПИК» 198216, г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 22
стр. 4, помещ. 18-Н, ком. 7, тел. +7 (812) 373-97-76, olimpik55@yandex.ru.

УТИЛИЗАЦИЯ: Изделие не воздействует на окружающую среду. Относится к классу А. Утилизируются как
эпидемиологически безопасные, твердые бытовые отходы.
Использованные изделия относятся к классу Б, обеззараживаются и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

REF

03.41000.731

LOT

C09



(01)04030155013729



НЕТТО: XX кг

БРУТТО: XX кг



REF 03.41000.731 LOT C09

Рукоять ларингоскопа KAWE
Рукоять фиброоптическая с ксеноновым
освещением 2,5В большая



2021-09

КАРХЕН Р. & НАЙМЛ Г.Л.М.Г. мбх. с. 40. КГ.
Заводской пр. 56, 11179 Аспер, Германия
Тел. +49 (0)2141 648 188 0. Факс +49 (0)2141 648 188 11
E-mail: info@kaymed.com, www.kaymed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
по вопросам полного обращения медицинских изделий:
ООО «ОЛИМП» 198216, г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного
Ополчения, д. 22 стр. 4, помещ. 18 Н, ком. 7, тел. +7 (812) 323-97-76,
olimp55@yandex.ru

РУ № _____ ОТ _____

Использованные изделия относятся к классу Б, обеззараживаются и
утилизуются в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.



(01)04030155013729

FA:123456

Прошито и пронумеровано

46 (сорок шесть) листов
Генеральный директор ООО «Олимпик»

Самошин И.А.

