

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ООО «КРАФТ»

С.И. Барышников

2021 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР В ВАРИАНТАХ  
ИСПОЛНЕНИЯ**


**г. Ставрополь**

**2021 г.**


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОХИМИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗАТОРА URIT-8210 И ЕГО КОМПЛЕКТУЮЩИХ**

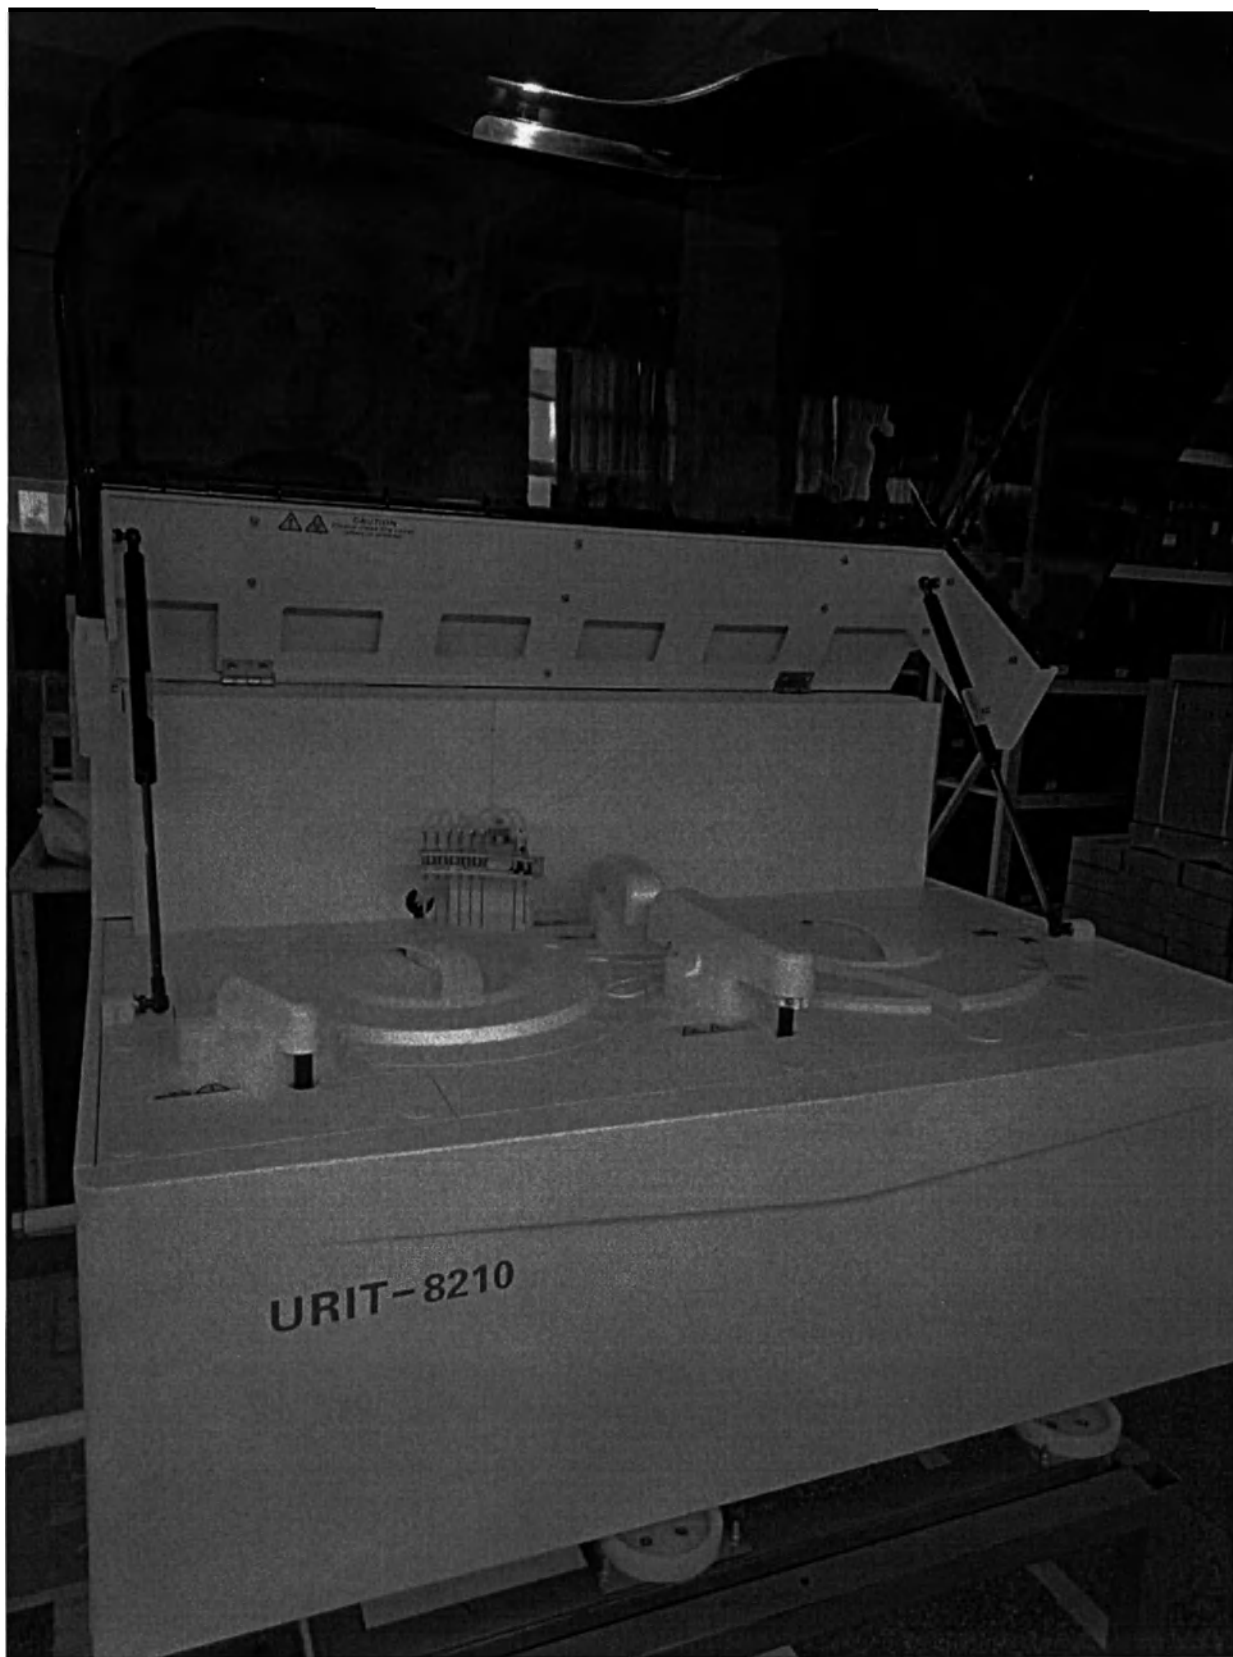

A)

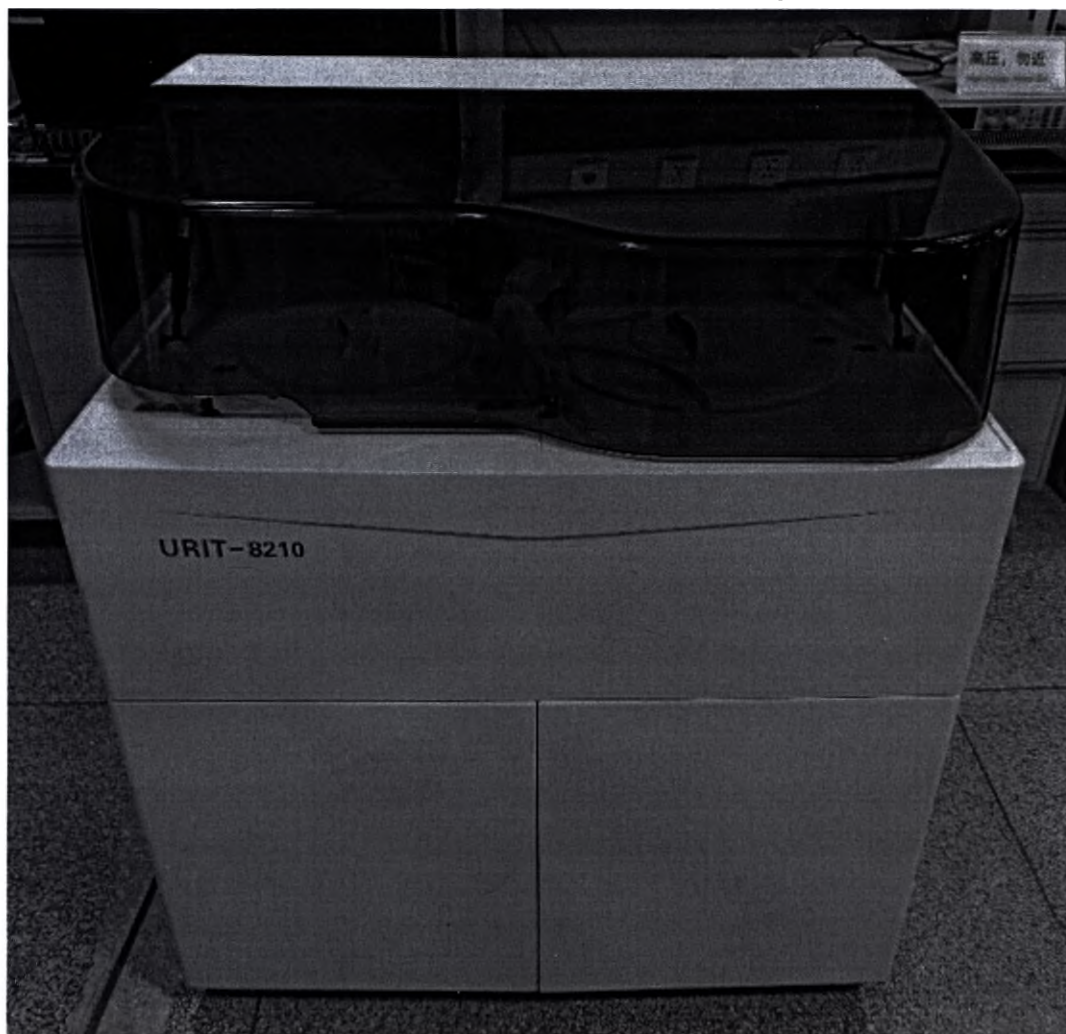

Б)

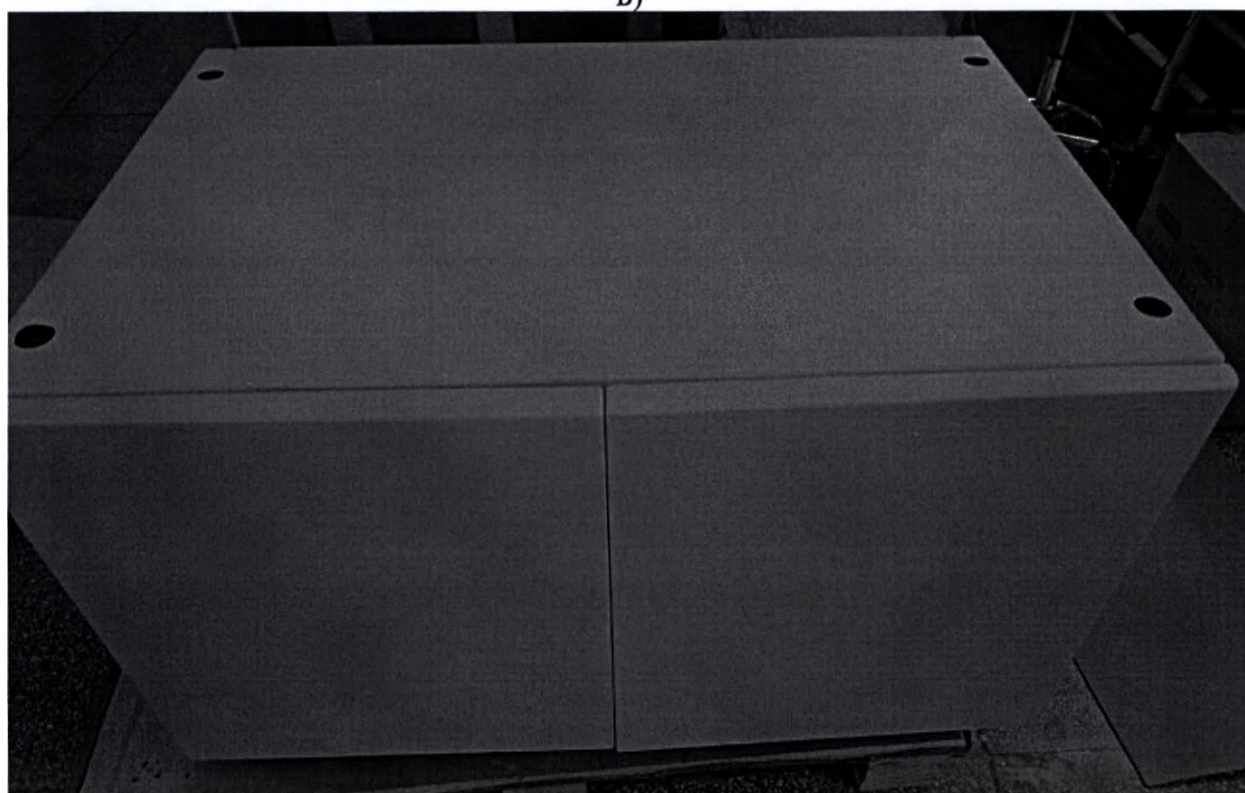

**Рисунок 1 – Вид спереди: А) Автоматический биохимический анализатор URIT-8210 (без подставки); Б) Автоматический биохимический анализатор URIT-8210 (с подставкой); В) Подставка для автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



Рисунок 2 – Вид сзади Автоматический биохимический анализатор URIT-8210



A)



Б)

Рисунок 3— А) Место для подключения кабеля питания от сети, кабеля заземления и кабеля последовательной связи; Б) Место для подключения трубок системы подачи воды, детергента, сливной трубки и трубок для отработанного раствора, и BNC-коннекторов соответственно



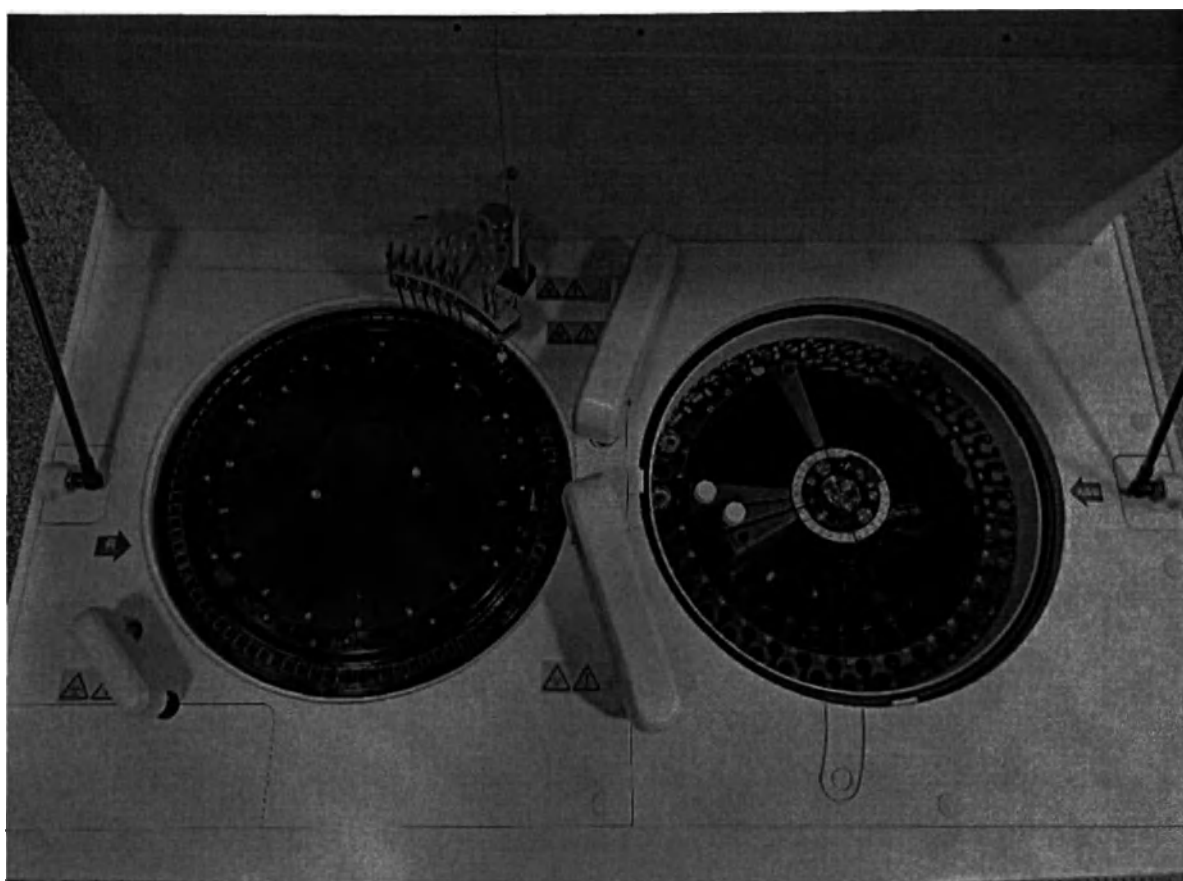


Рисунок 4 – Внешний вид рабочей поверхности Автоматического биохимического анализатора URIT-8210

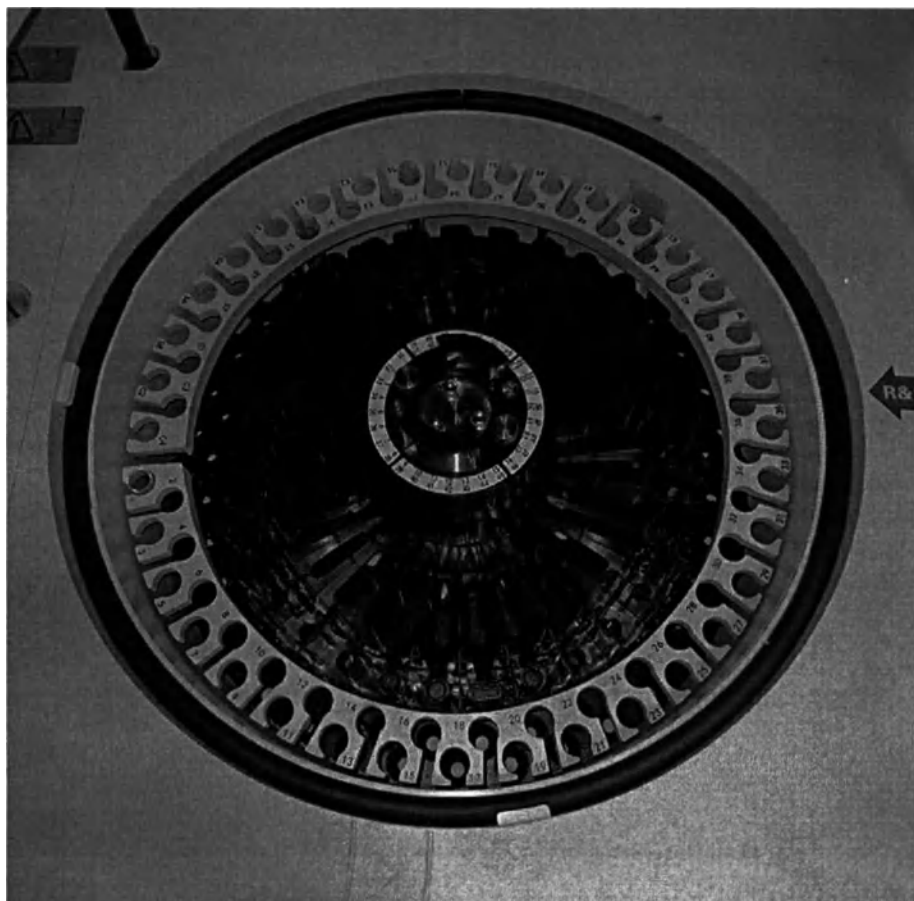

**Рисунок 5— Диск проб/реагентов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

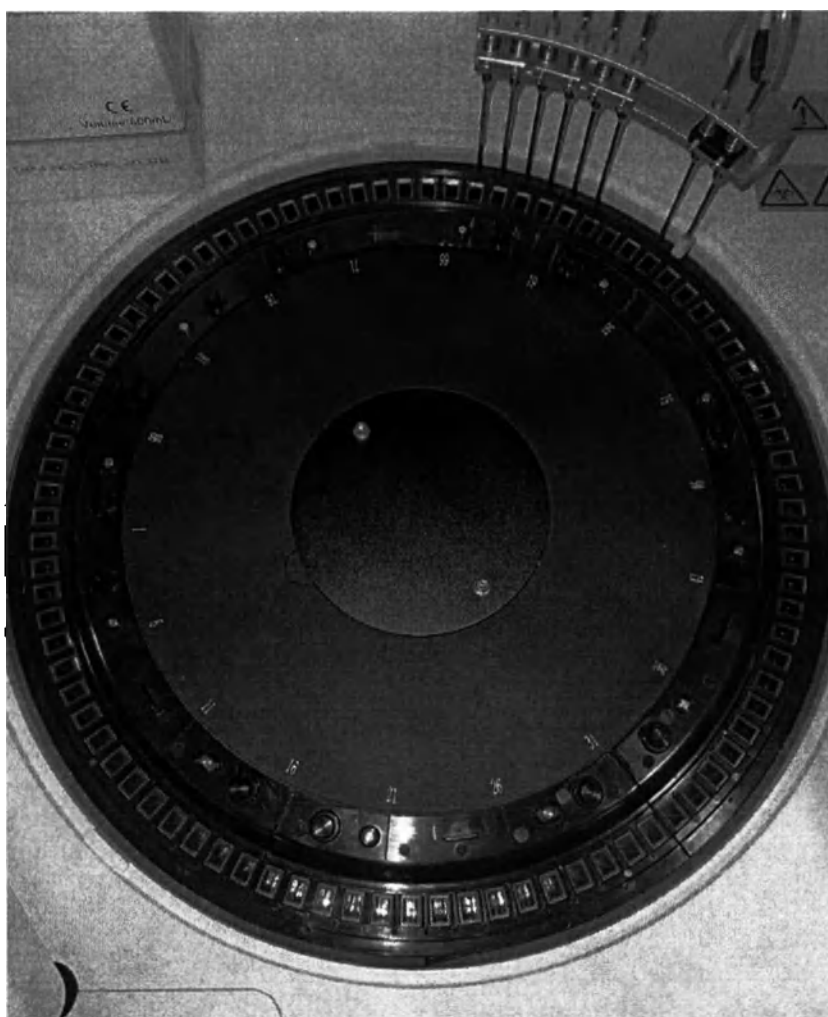

**Рисунок 6 – Внешний вид реакционного диска Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

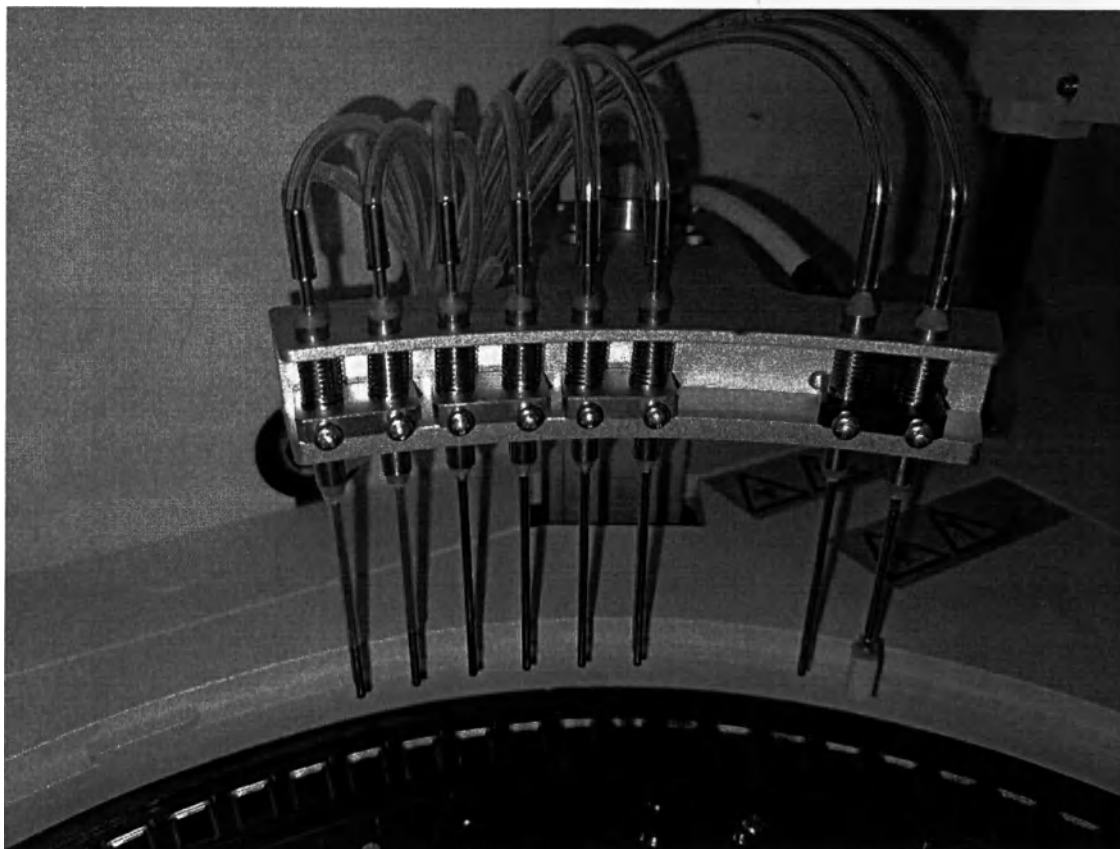


Рисунок 7 – Механизм очистки реакционного диска Автоматического биохимического анализатора URIT-8210



Рисунок 8 – Кабель питания от сети Автоматического биохимического анализатора URIT-8210

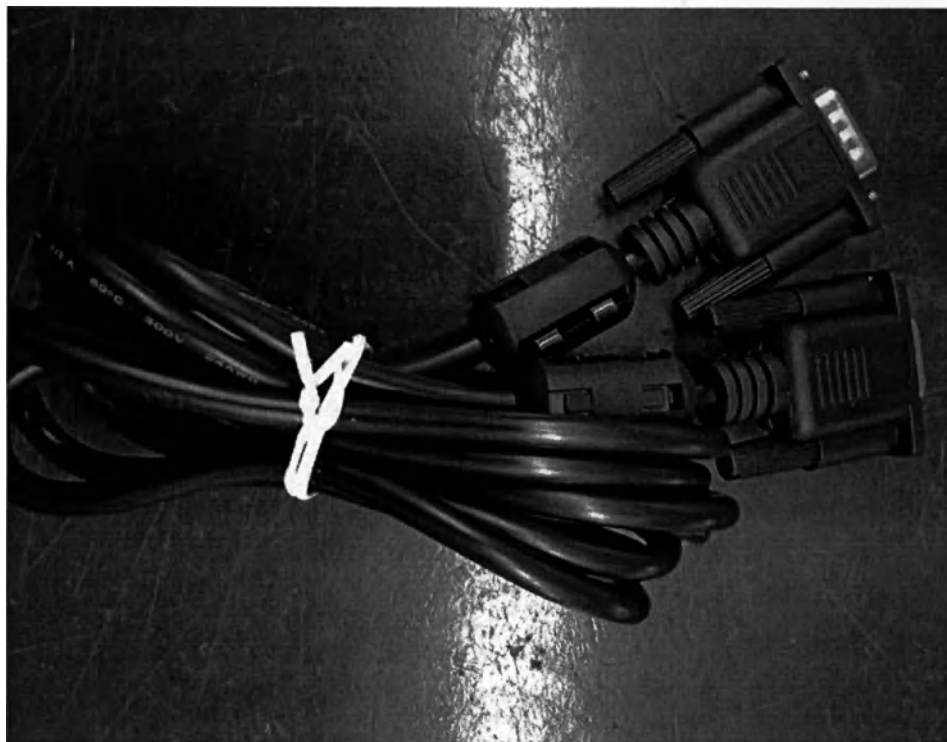


Рисунок 9 – Кабель последовательной связи Автоматического биохимического анализатора URIT-8210



Рисунок 10 – Кабель заземления Автоматического биохимического анализатора URIT-8210

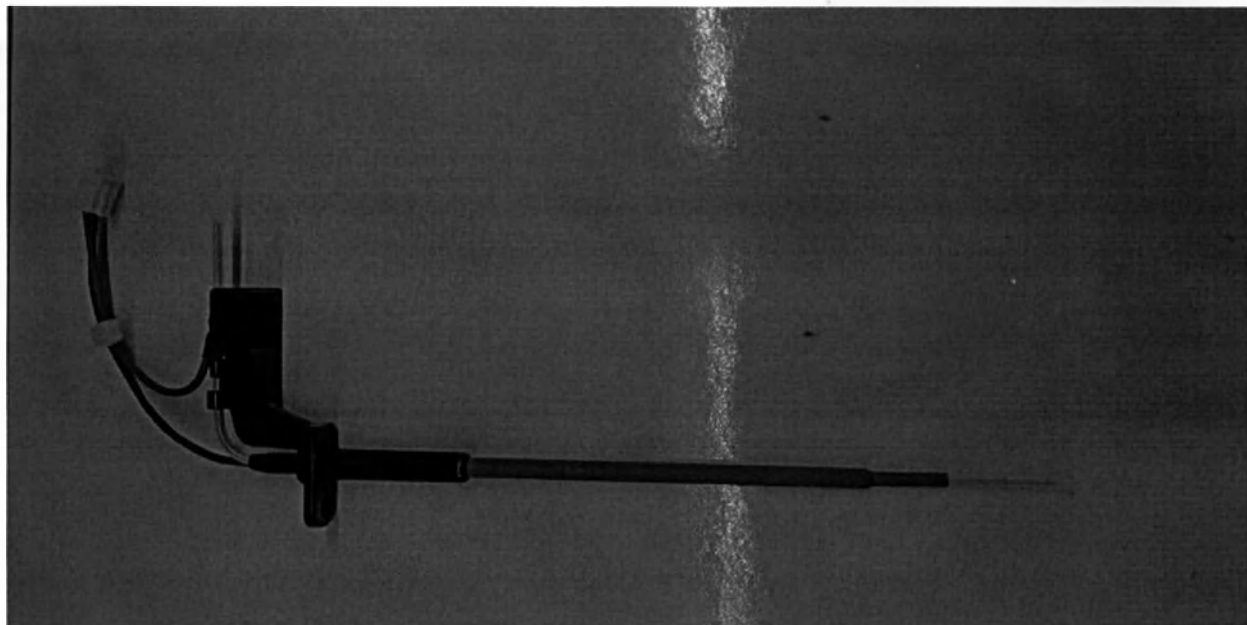


Рисунок 11 – Зонд для проб Автоматического биохимического анализатора URIT-8210

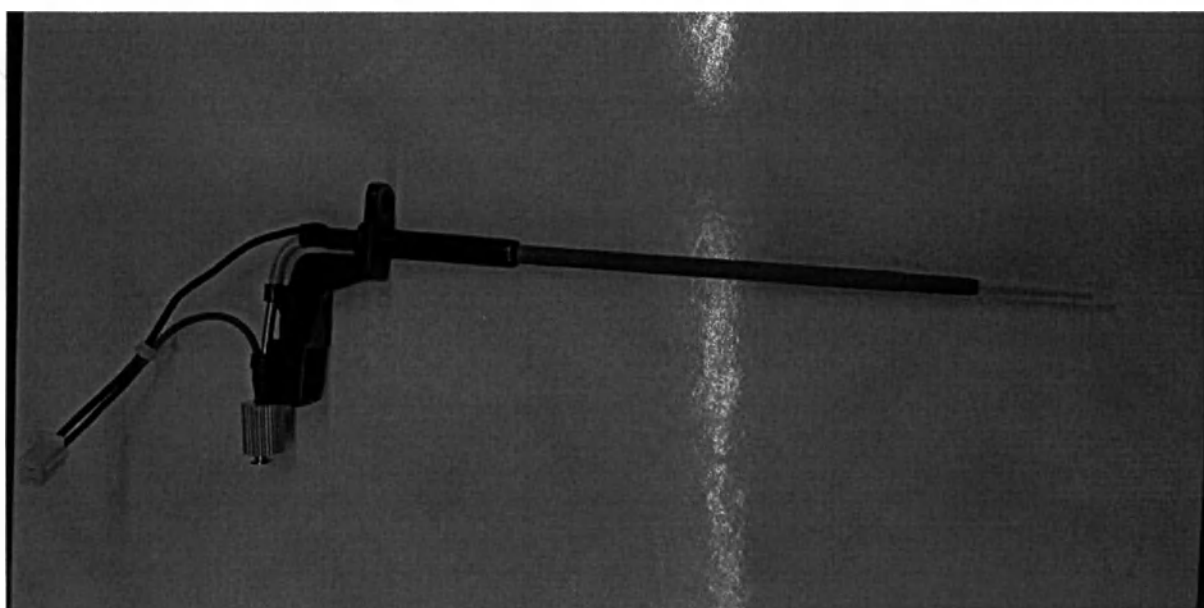


Рисунок 12 – Зонд для реагентов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210


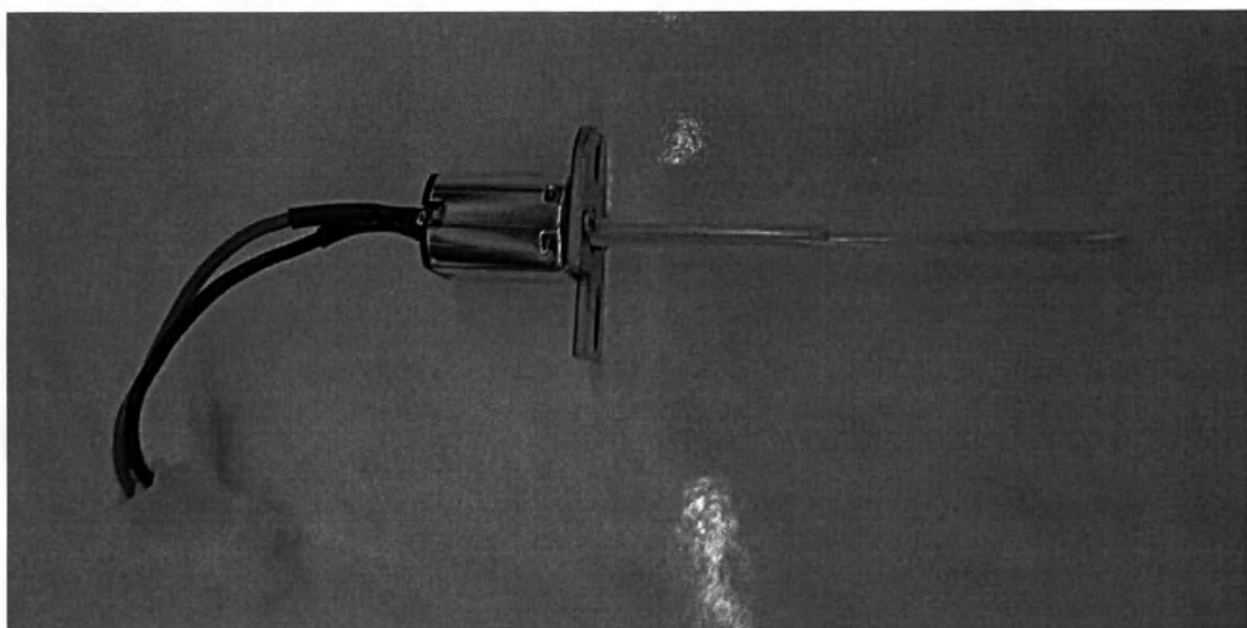


Рисунок 13 – Зонд для перемешивания реагентов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210




**Рисунок 14 – BNC-коннектор для дистиллированной воды Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

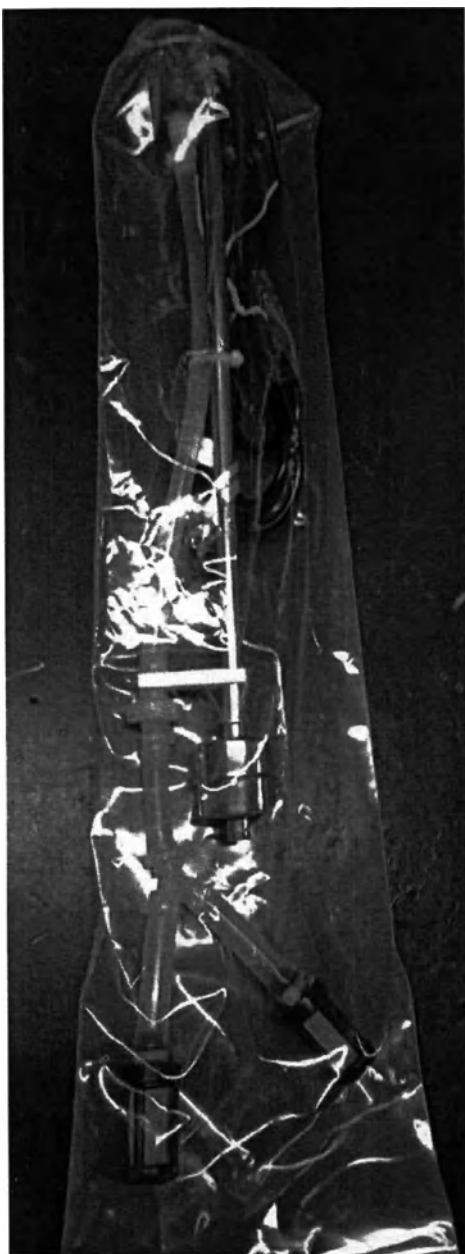


**Рисунок 15 – BNC-коннектор для отходов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



**Рисунок 16 – BNC-коннектор для детергента Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

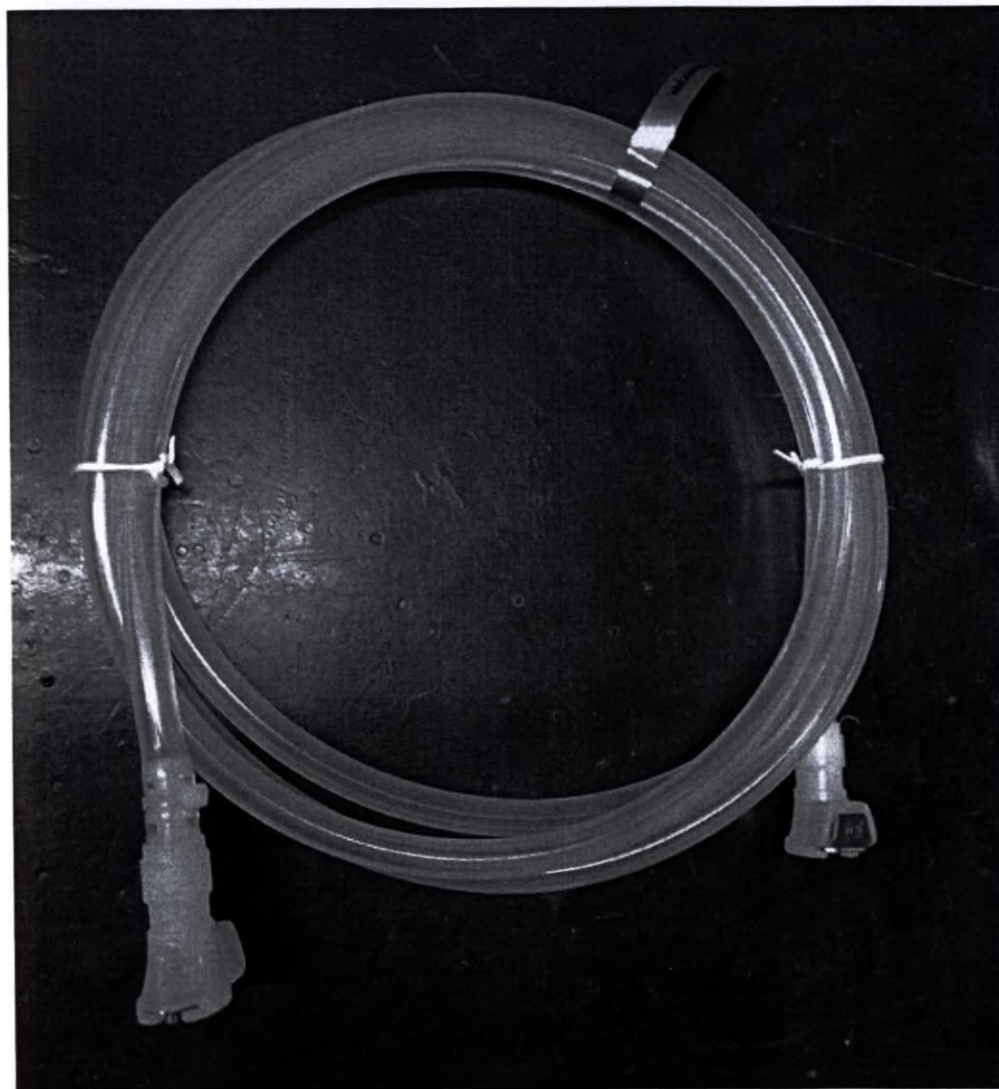

**Рисунок 17 – Трубка для дистиллированной воды Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

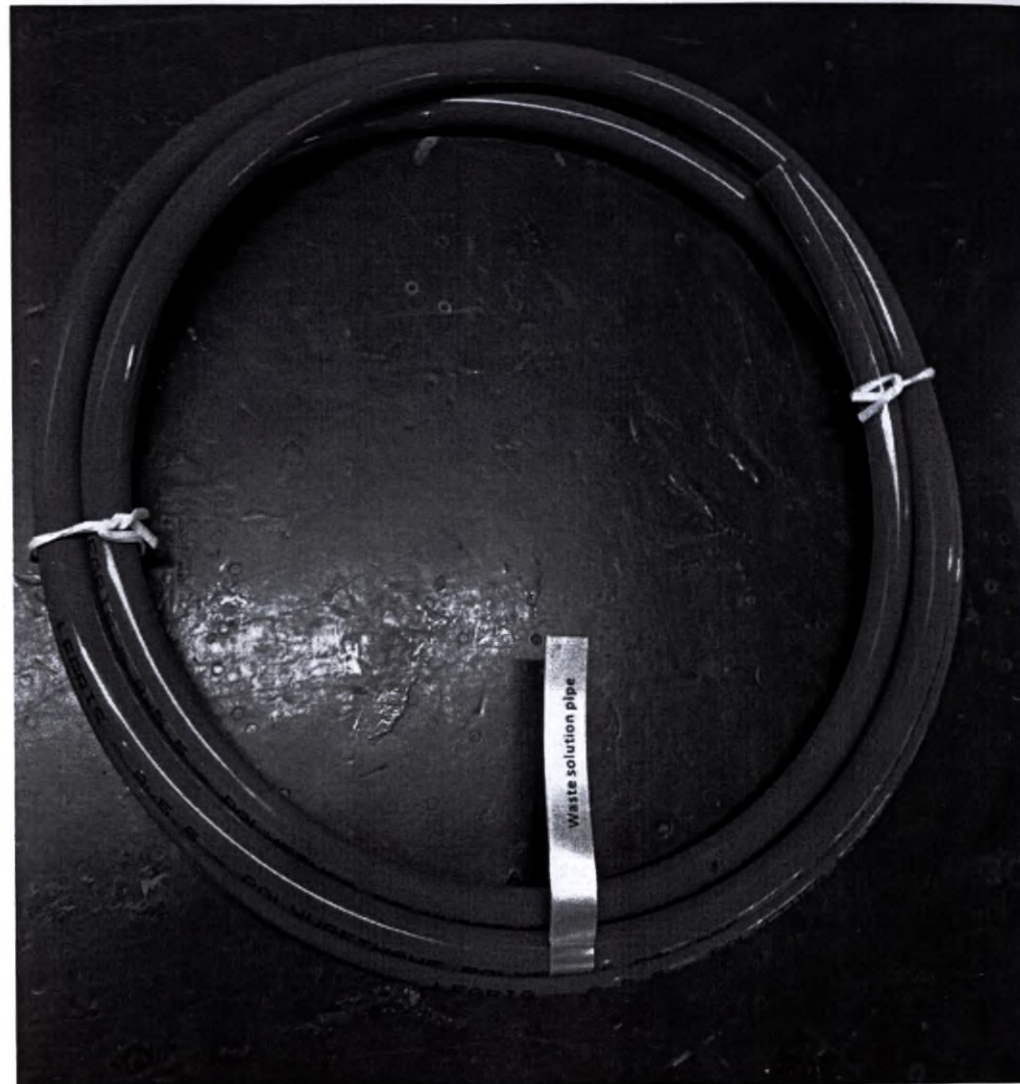

**Рисунок 18 – Трубка для слива отходов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



**Рисунок 19 – Трубка для детергента  
Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



**Рисунок 20 – Сливная трубка Автоматического биохимического анализатора  
URIT-8210**



**Рисунок 21 – Флаконы для реагентов 20 мл Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**





**Рисунок 22 – Флаконы для реагентов 50 мл Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



**Рисунок 23 – Колпачки для флаконов с реагентами Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



**Рисунок 24 – Чашечки для образцов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

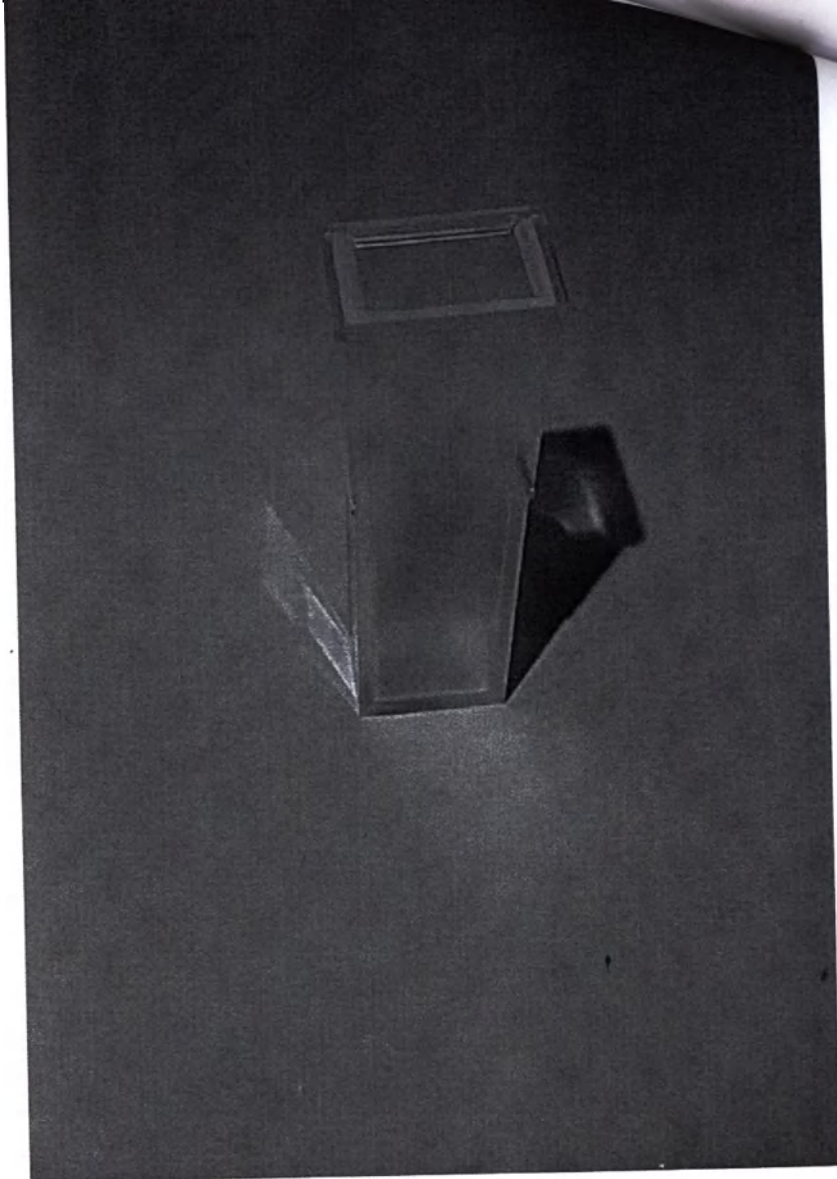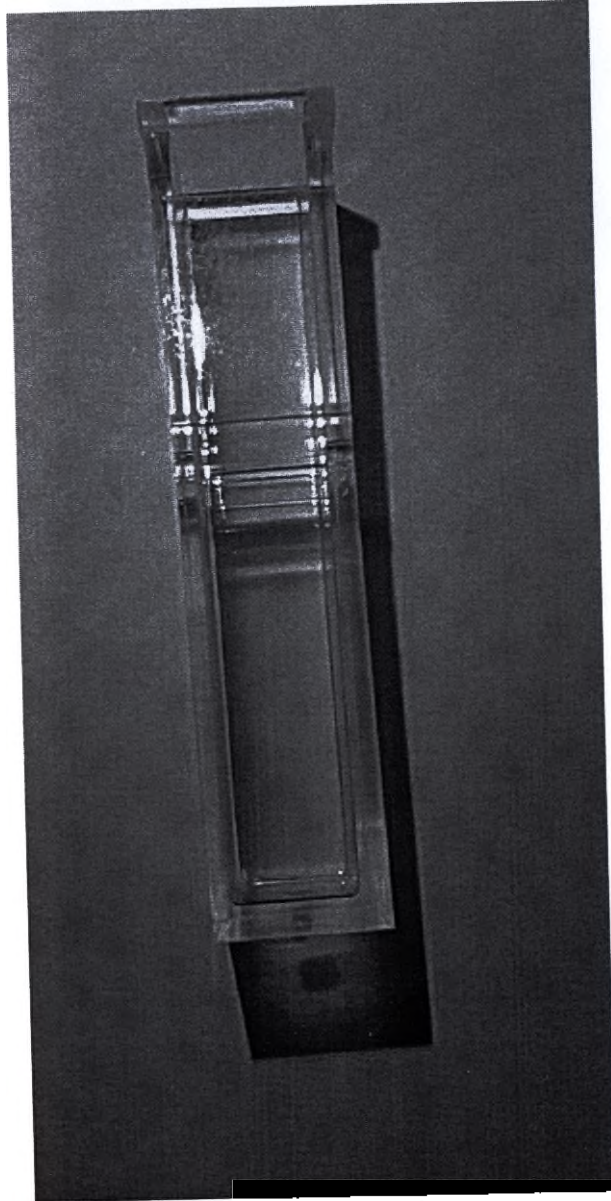

**Рисунок 25 – Кювета измерительная Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

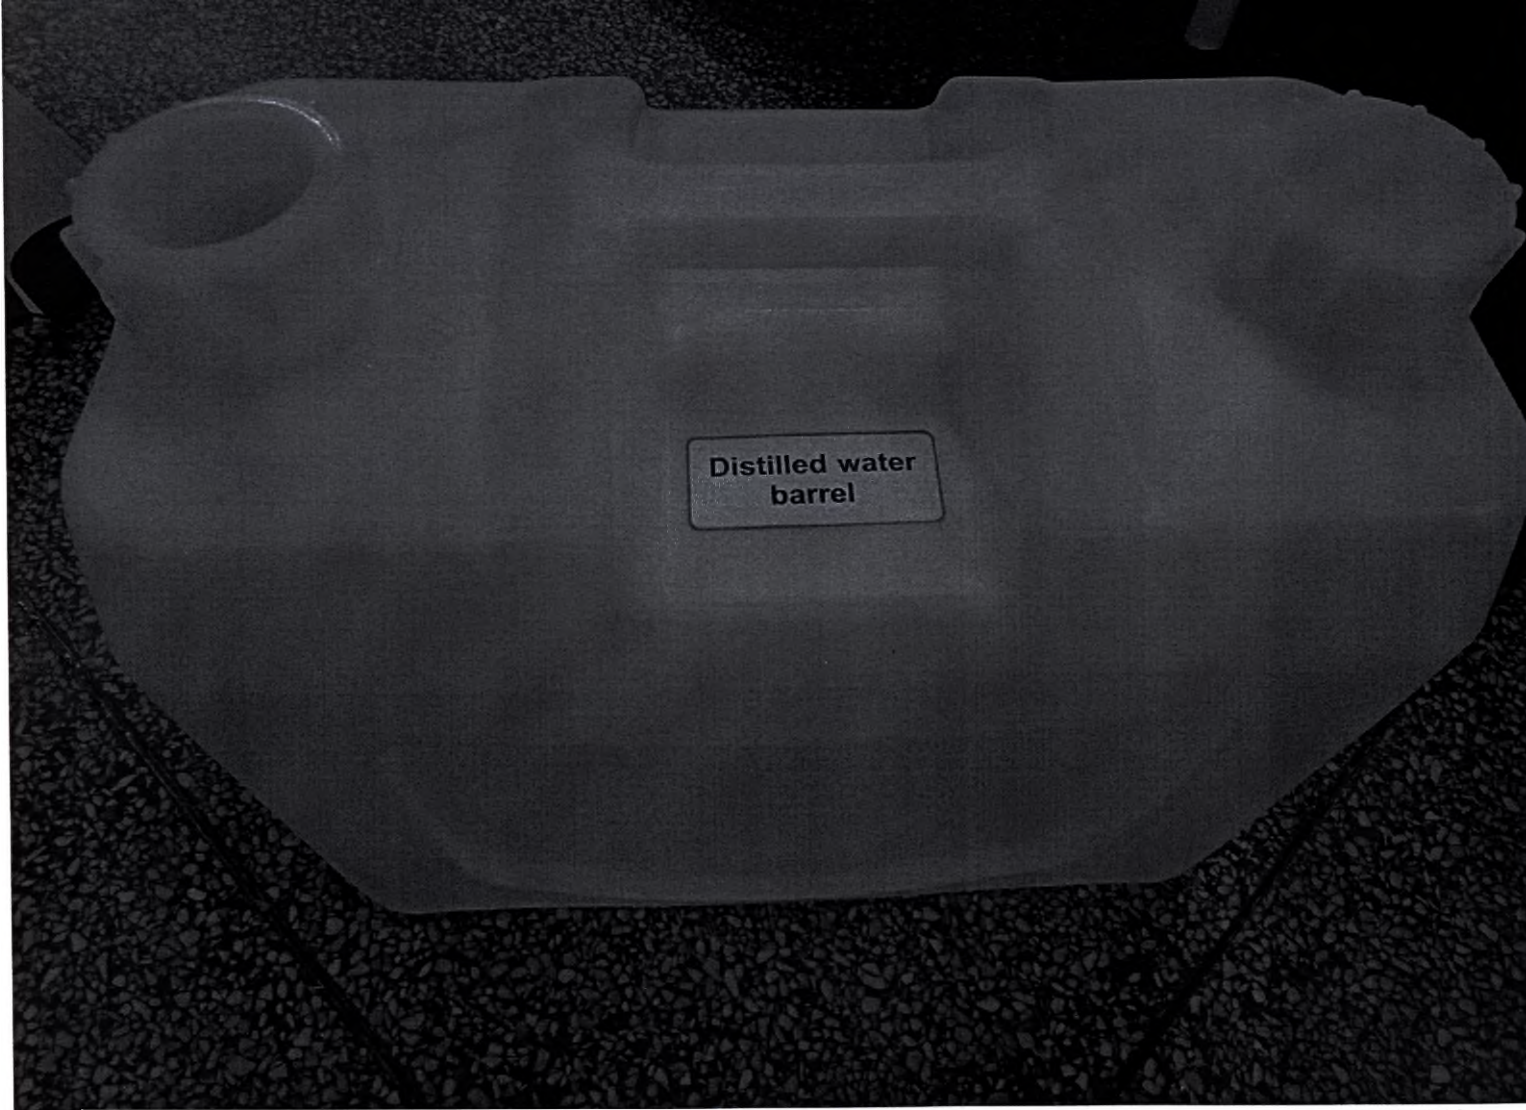


Рисунок 26 – Емкость для дистиллированной воды Автоматического биохимического анализатора URIT-8210



Рисунок 27 – Емкость для слива отходов Автоматического биохимического анализатора URIT-8210



Рисунок 28 – Емкость для детергента Автоматического биохимического анализатора URIT-8210



Рисунок 29 – набор ключей шестигранников 1.5-4.0



Рисунок 30 – набор крестовых отверток



Рисунок 31 – Винт M2.5x6



Рисунок 32 – Заглушка для отверстий



Рисунок 33 – Фильтр для воды

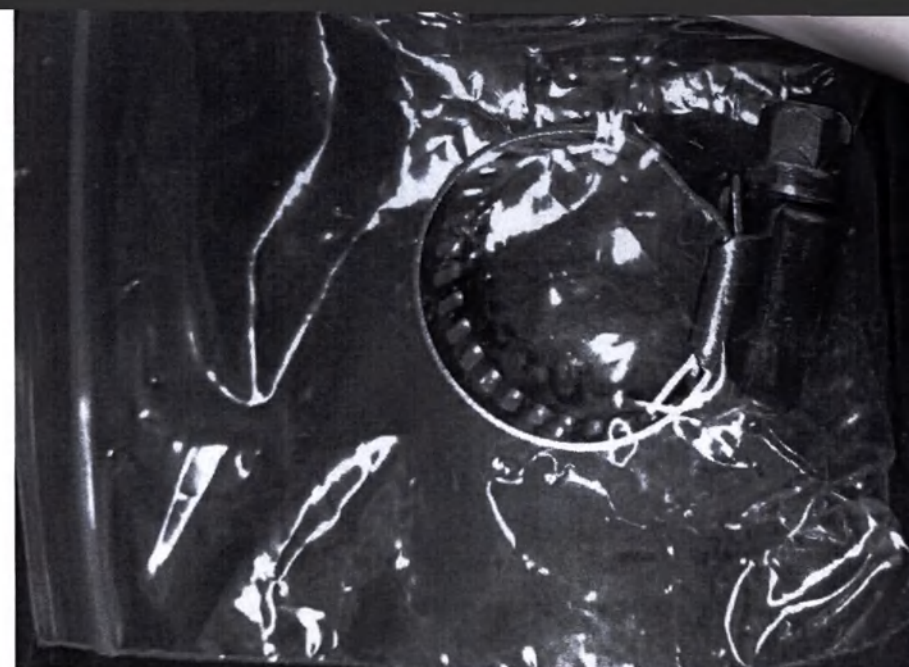


Рисунок 34 – Хомут


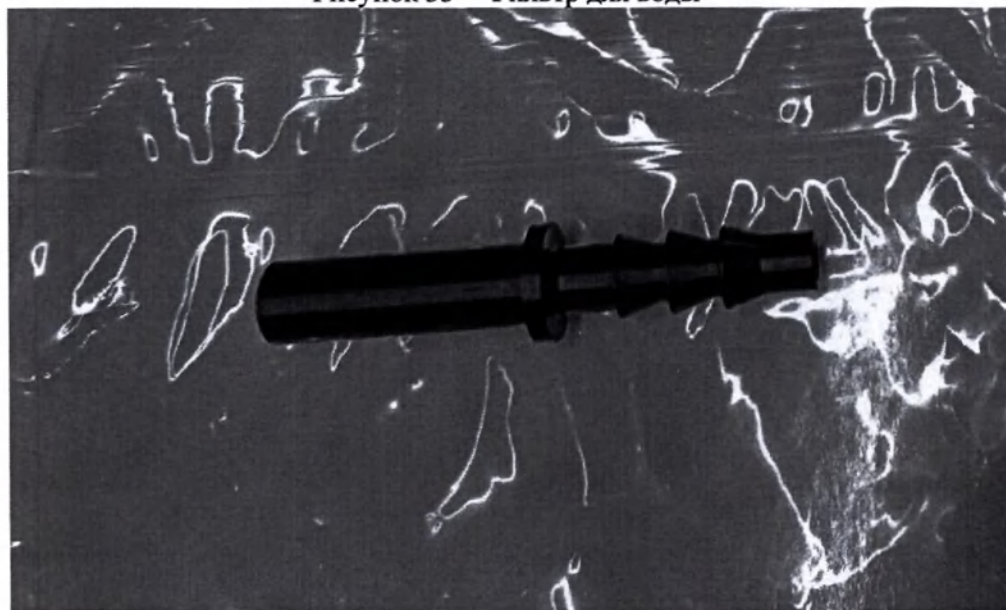


Рисунок 35 – 3/16 быстроразъемный штекер 1/4




Рисунок 36 – Абразивная бумага

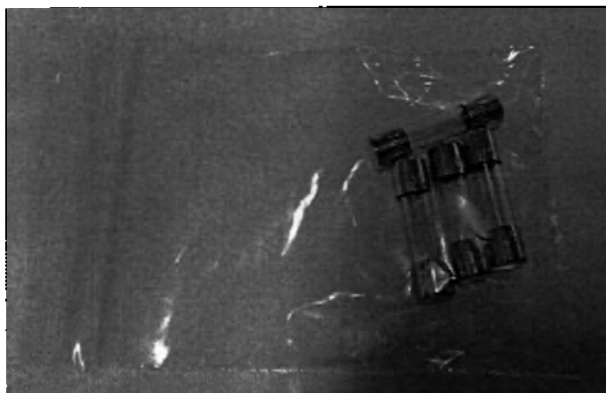

**Рисунок 37 – Предохранитель Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



**Рисунок 38 – Мандрен для прочистки зонда**

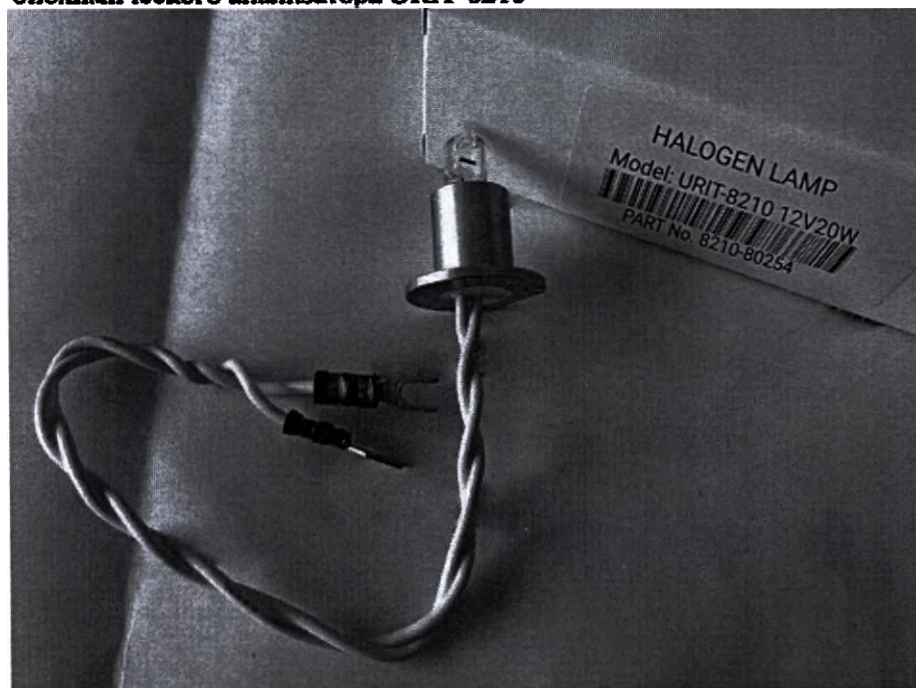

**Рисунок 39 – Галогенная лампа 12 В/20 Вт**



**Рисунок 40 – CD диск для установки программного обеспечения для Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**

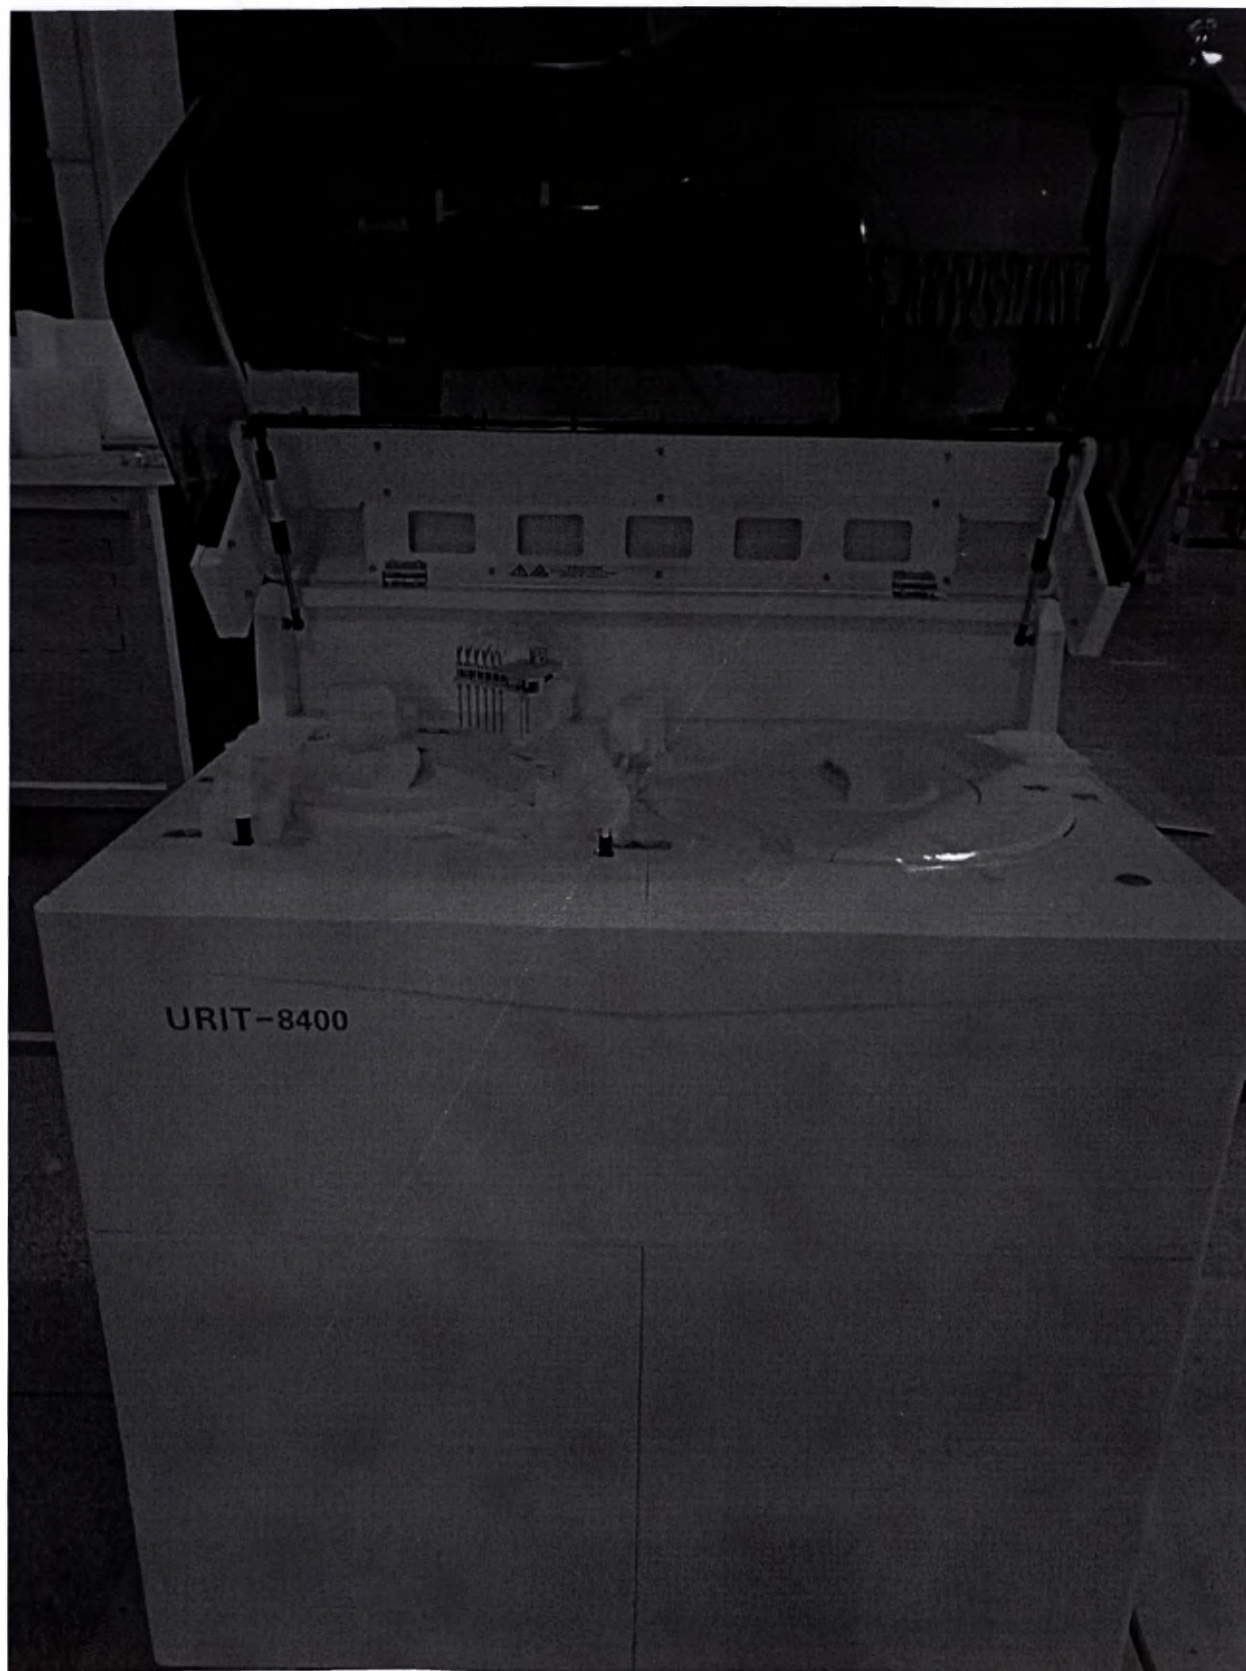


Рисунок 41 – Вид спереди Автоматический биохимический анализатор URIT-8400



**Рисунок 42 – Вид сзади Автоматический биохимический анализатор URIT-8400**

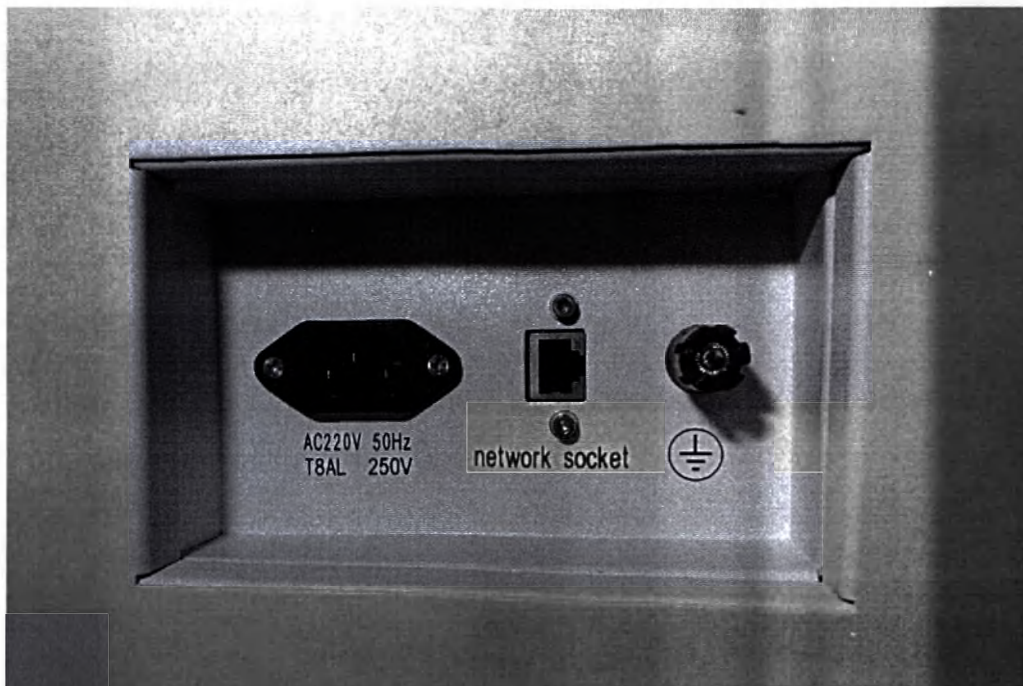


Рисунок 43— Место для подключения кабеля питания от сети, кабеля заземления и кабеля последовательной связи Автоматического биохимического анализатора URIT-8400



Рисунок 44— Место для подключения системы подачи воды и водоотведения, а также для подключения трубок для детергента, слива отходов и их BNC-коннекторов, соответственно Автоматического биохимического анализатора URIT-8400


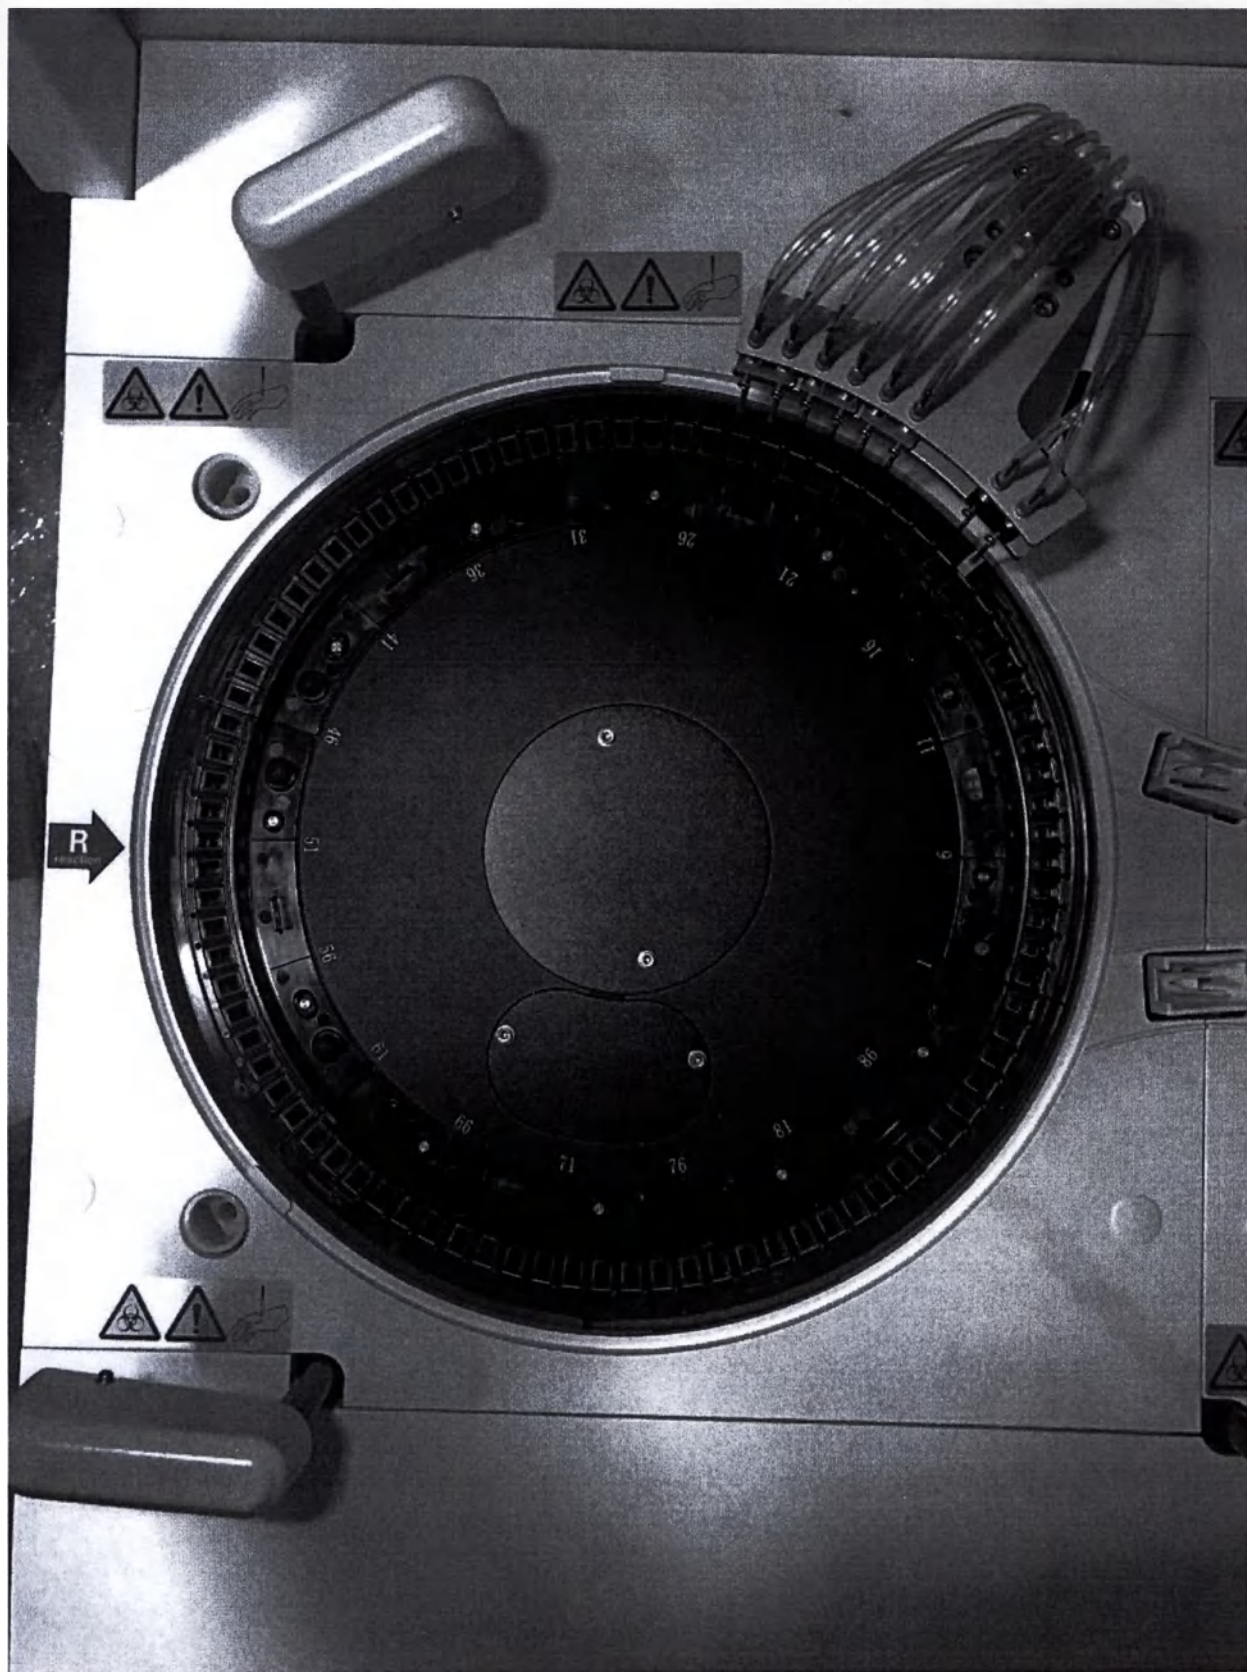


Рисунок 45 – Внешний вид реакционного диска Автоматического биохимического анализатора URIT-8400




А)

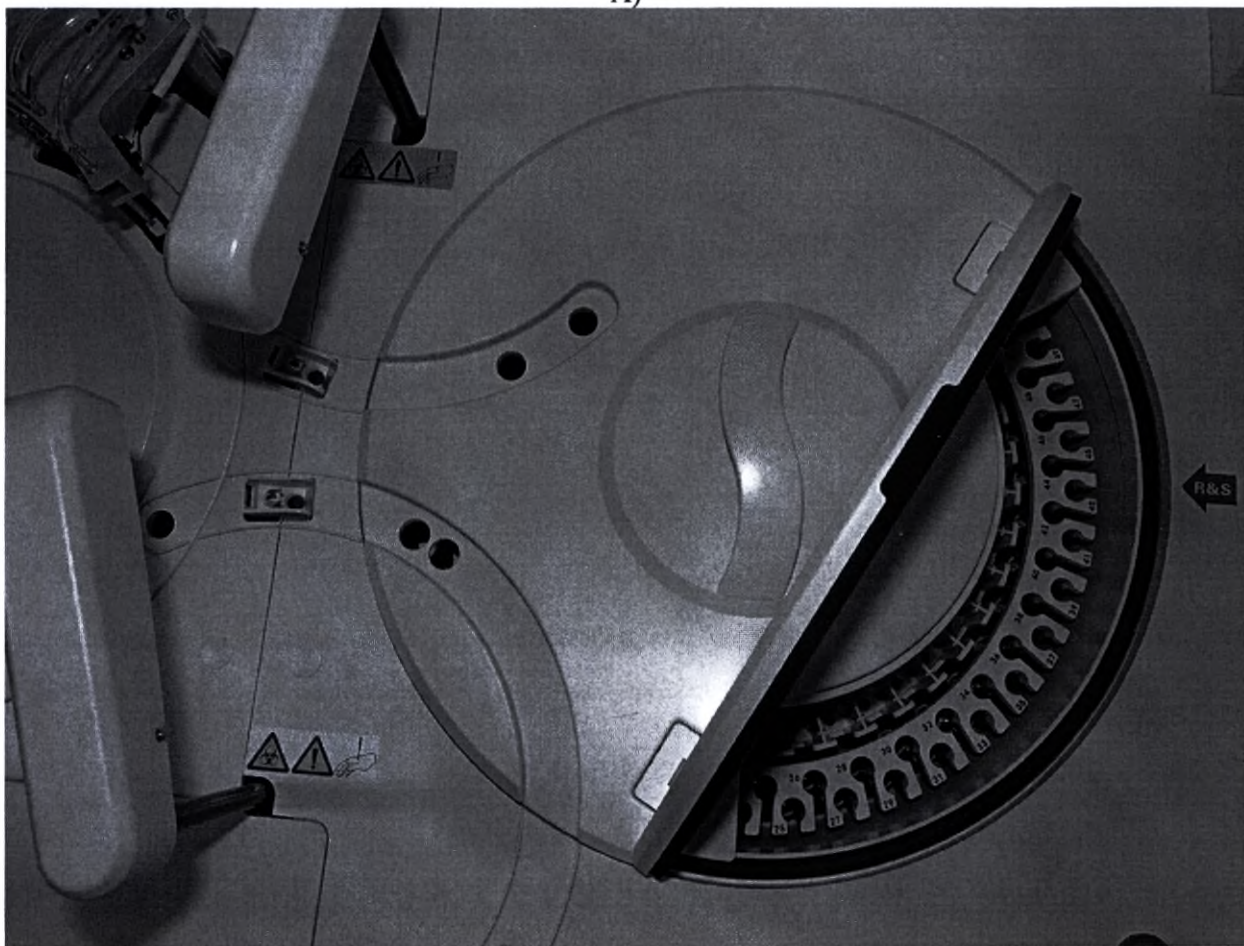

Б)

Рисунок 46 – А) Диск проб/реагентов (без крышки); Б) Диск проб/реагентов (с установленной крышкой) Автоматического биохимического анализатора URIT-8400

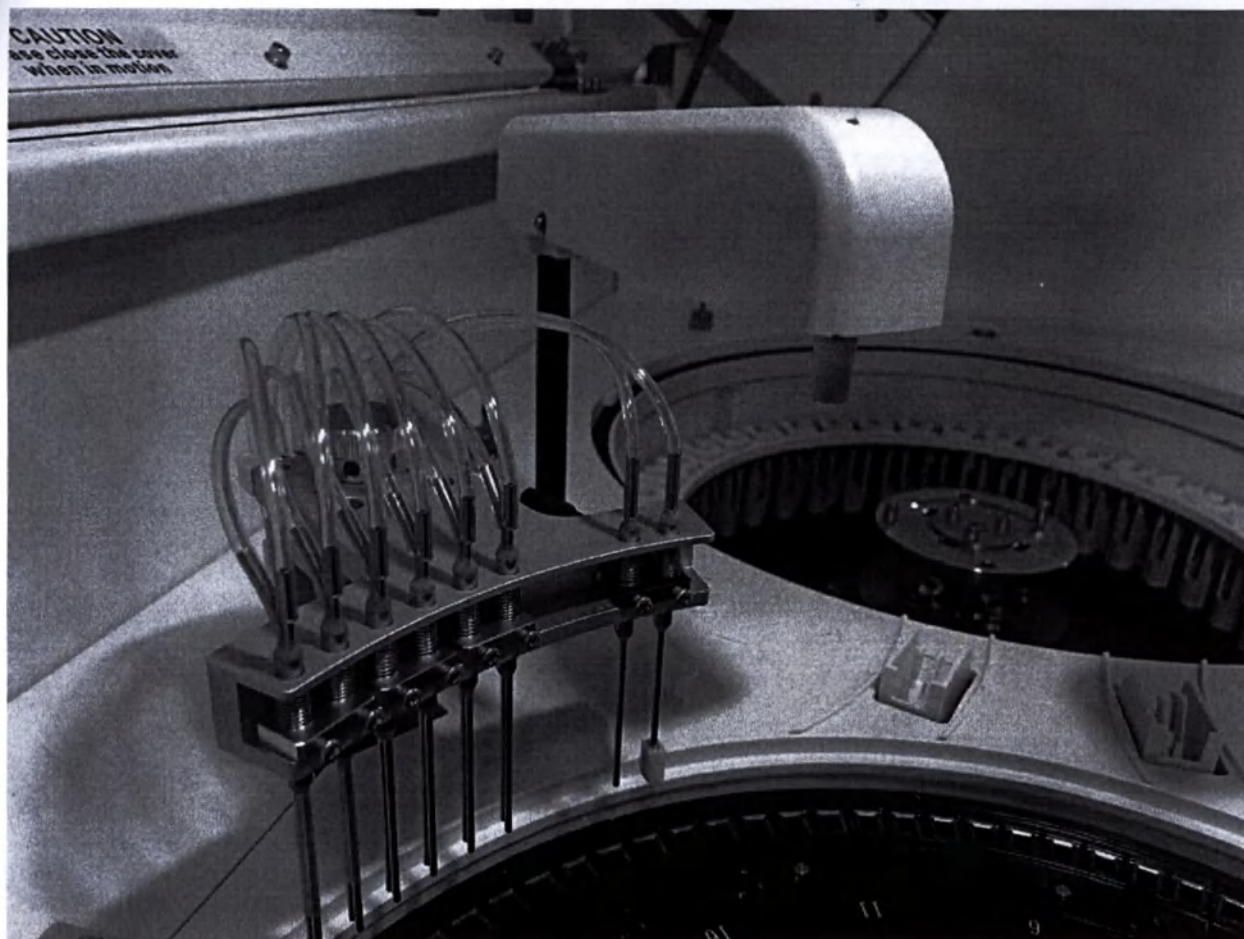

**Рисунок 47 – Механизм очистки реакционного диска Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



**Рисунок 48 – Кабель питания от сети Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**




**Рисунок 49 – Кабель подключения к сети  
Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**




**Рисунок 50 – Кабель заземления Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



**Рисунок 51 – Зонд для проб Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**

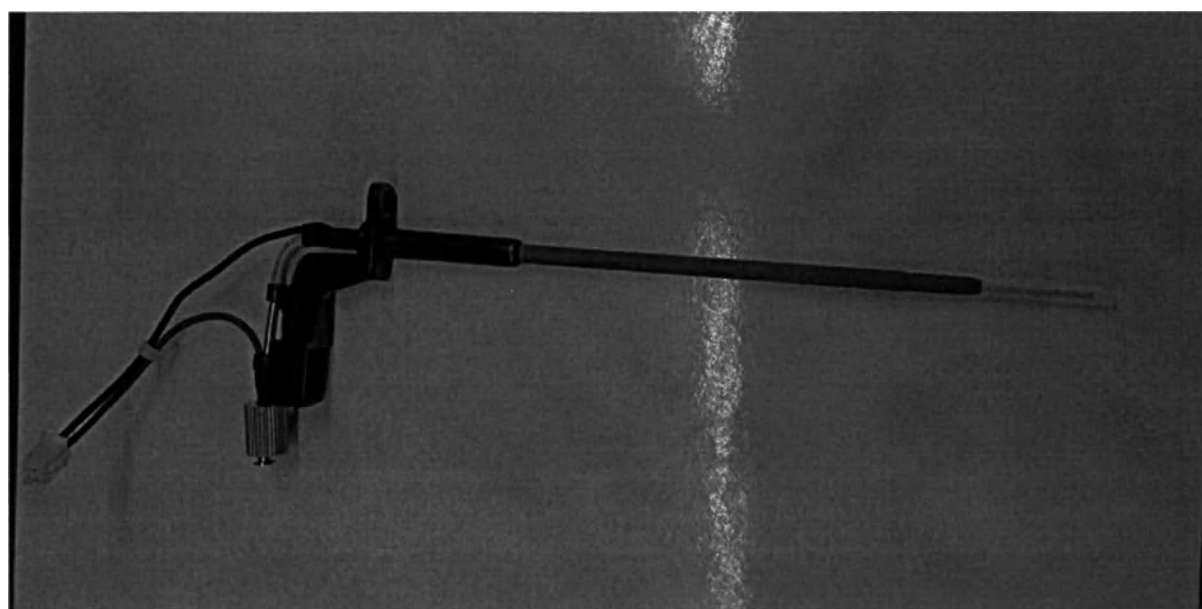

**Рисунок 52 – Зонд для реагентов Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**

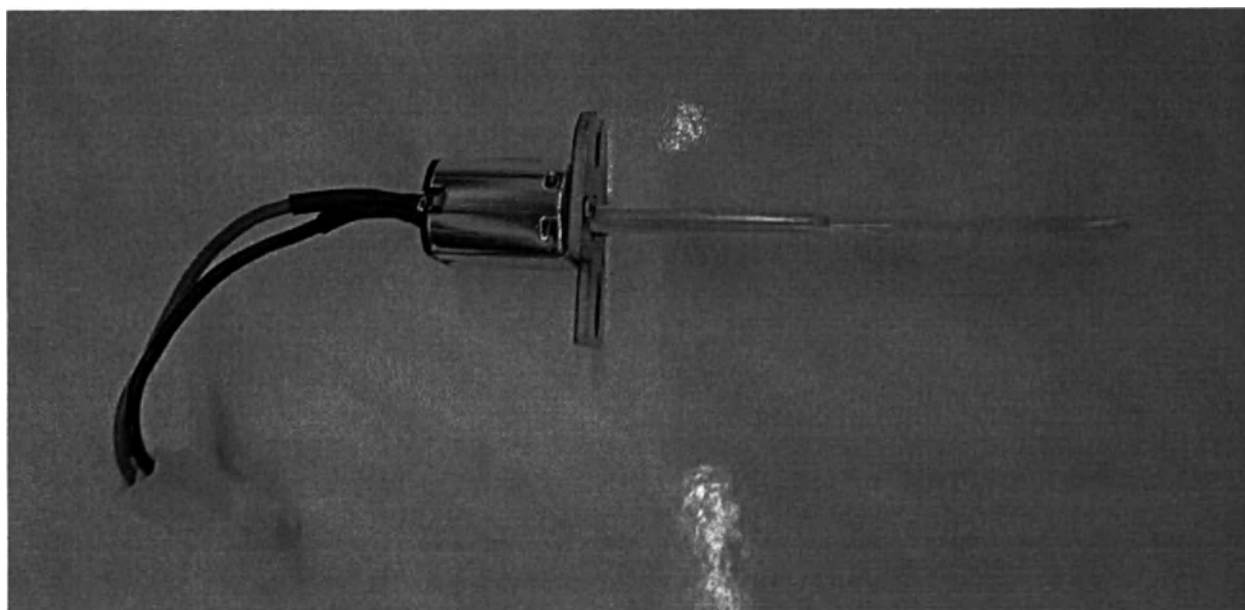

**Рисунок 53 – Зонд для перемешивания реагентов Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



Рисунок 54 – Зонд для перемешивания проб Автоматического биохимического анализатора URIT-8400




**Рисунок 55 – BNC-коннектор для дистиллированной воды Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**




**Рисунок 56 – BNC-коннектор для отходов Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**




**Рисунок 57 – BNC-коннектор для детергента Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**

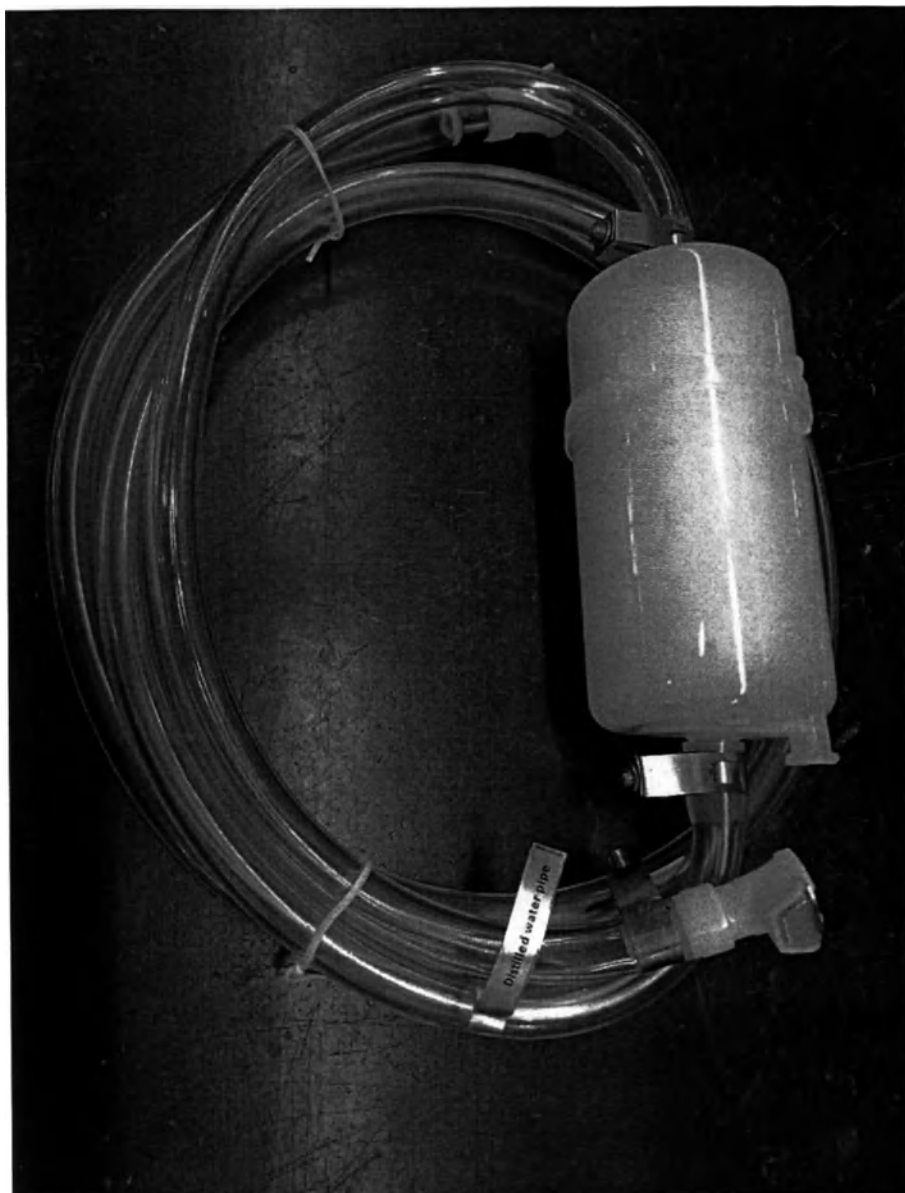


**Рисунок 58 – Трубка для дистиллированной воды Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



**Рисунок 59– Трубка для слива отходов Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**

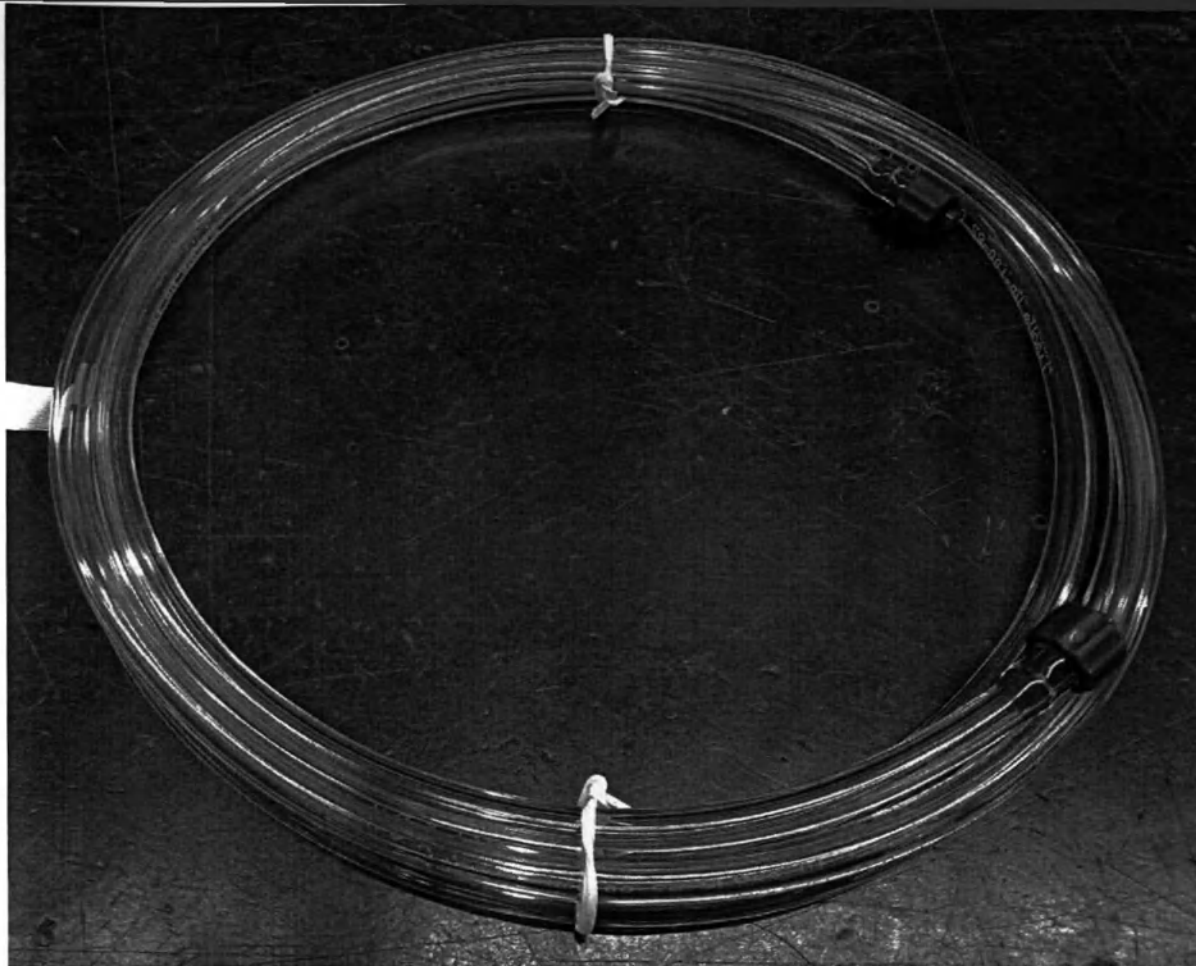

**Рисунок 60 – Трубка для детергента  
Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**

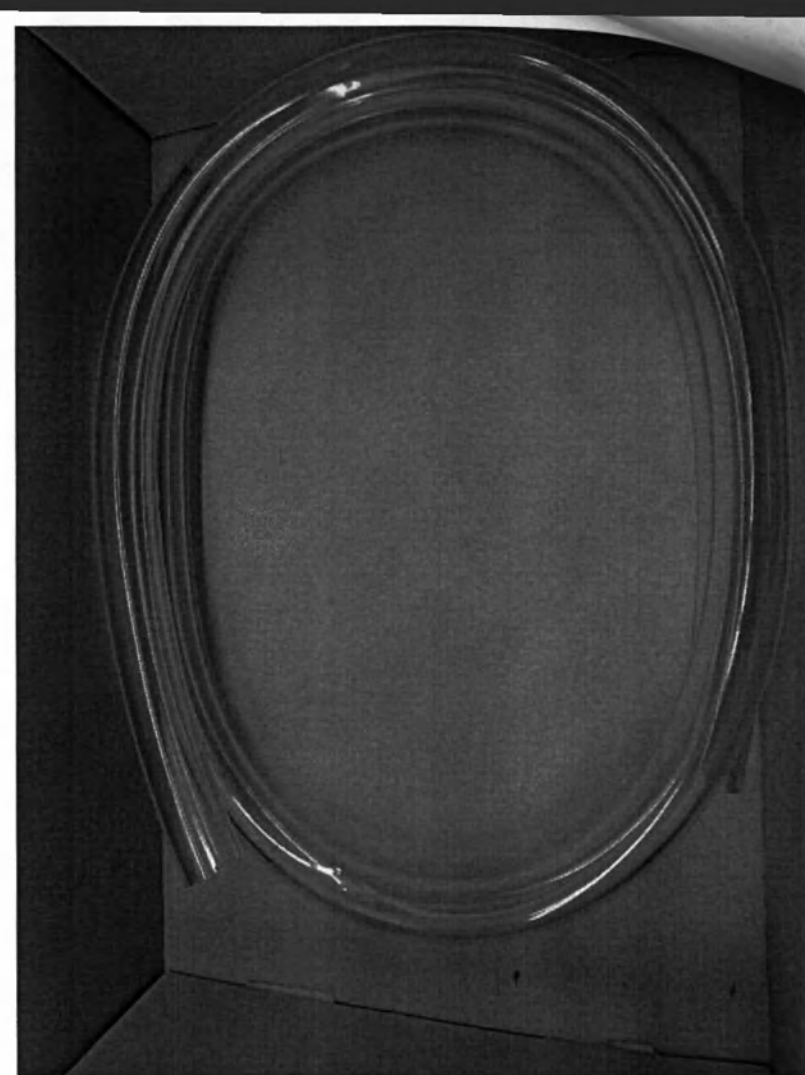

**Рисунок 61– Сливная трубка Автоматического биохимического  
анализатора URIT-8400**



**Рисунок 62 – Флаконы для реагентов 20 мл Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



**Рисунок 63– Флаконы для реагентов 50 мл Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**


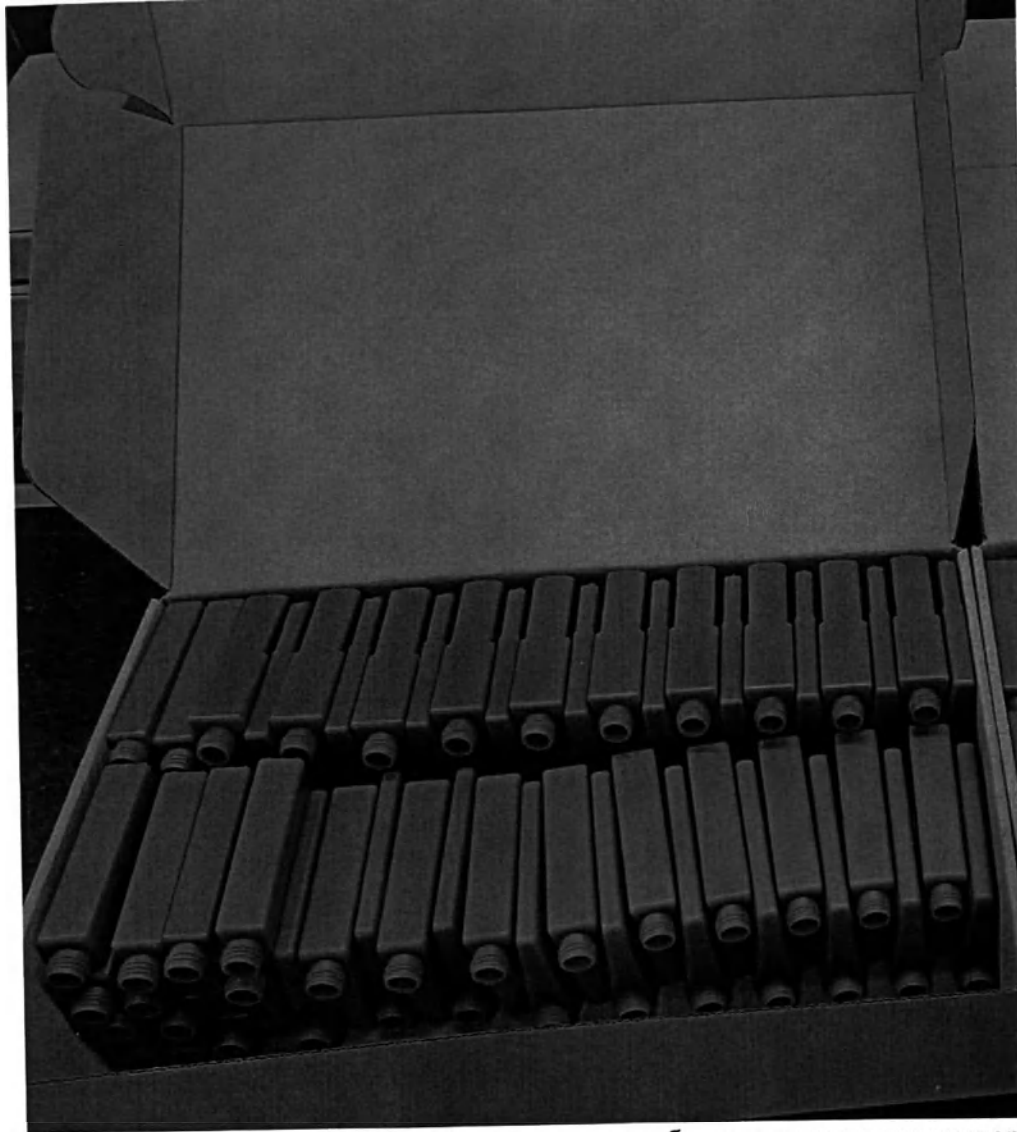




Рисунок 64 – Флаконы для реагентов 70 мл Автоматического биохимического анализатора URIT-8400

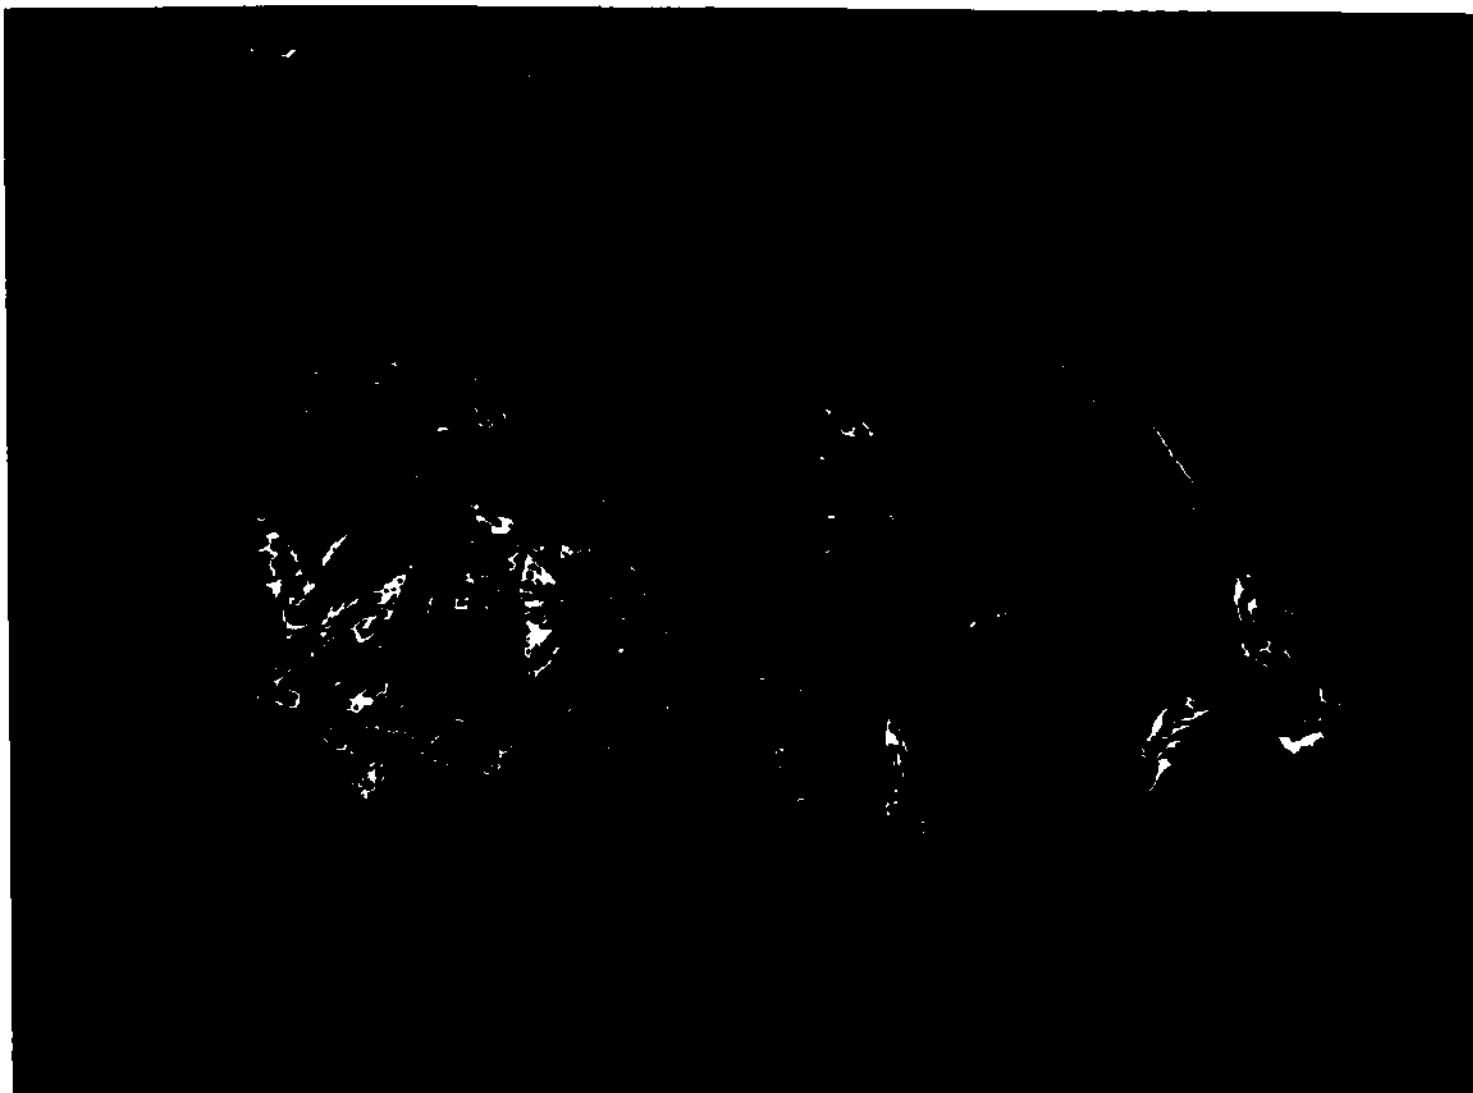

**Рисунок 65 – Колпачки для флаконов с реагентами Автоматического биохимического анализатора URIT-8210**



Рисунок 66– Чашечки для образцов Автоматического биохимического анализатора URIT-8400

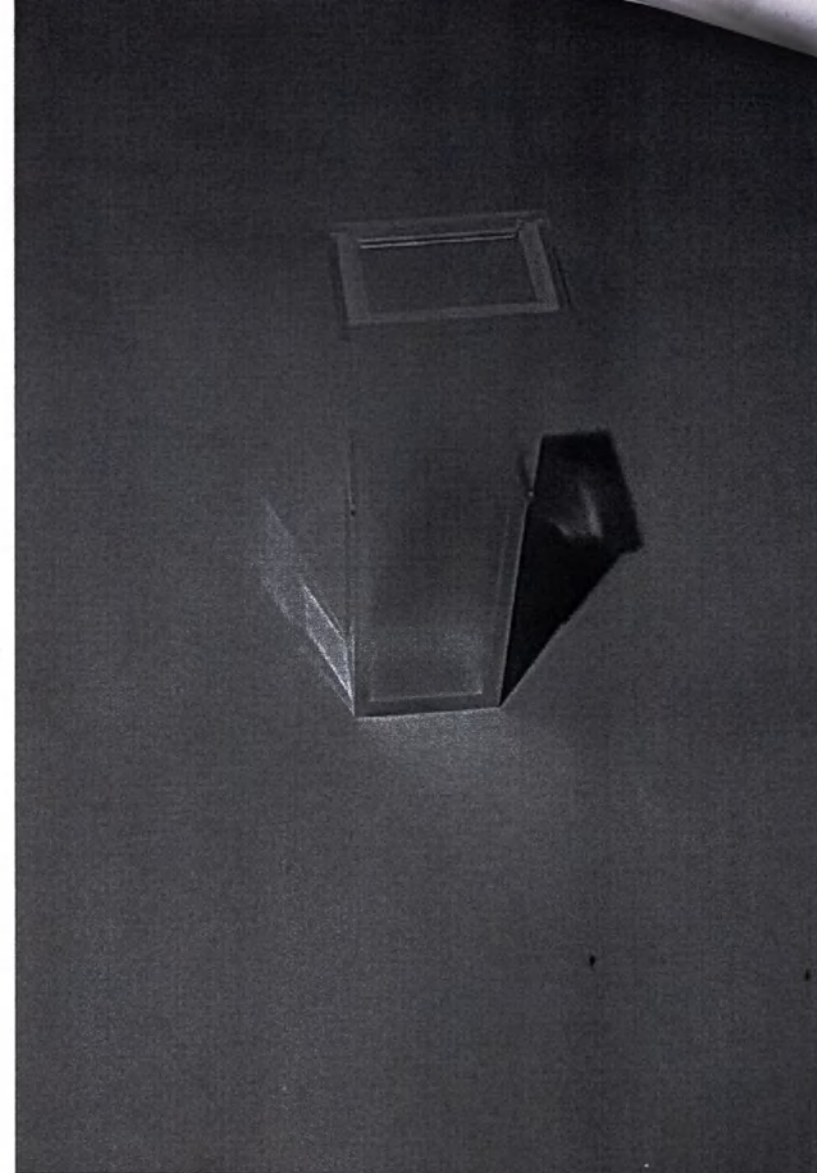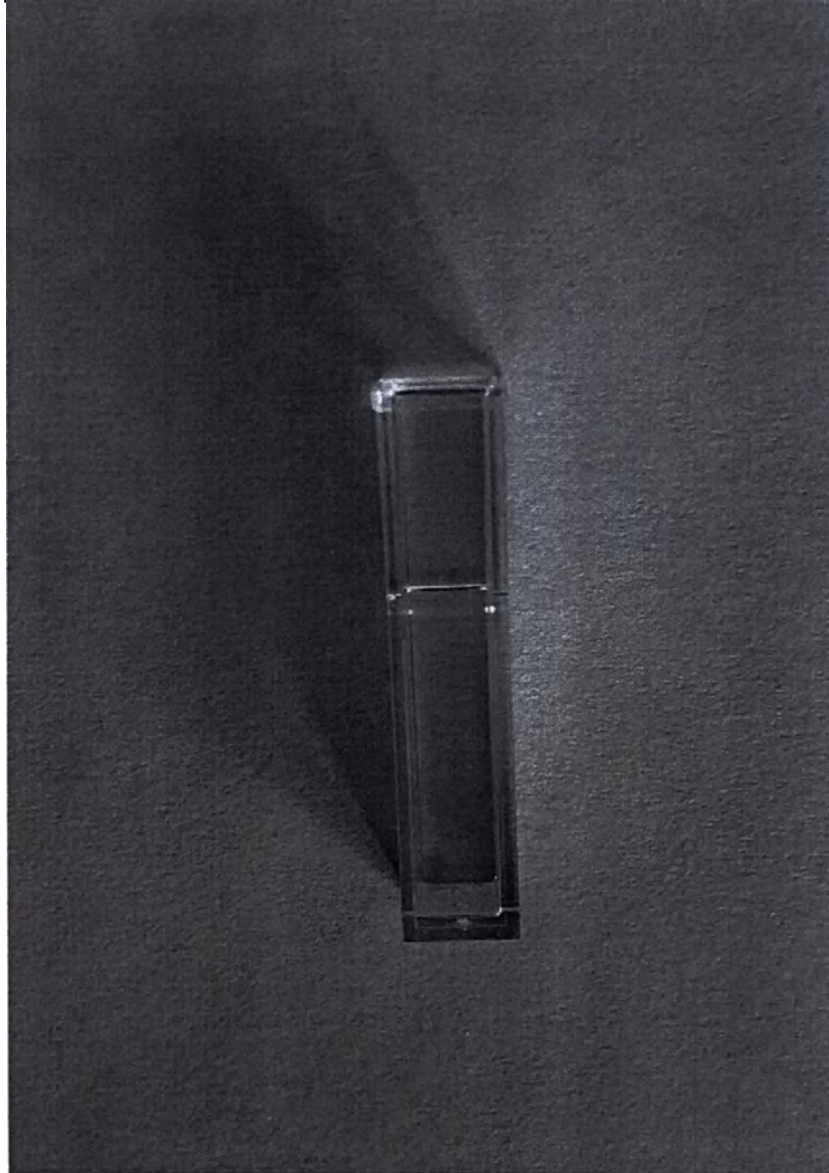

**Рисунок 67 – Кювета измерительная Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



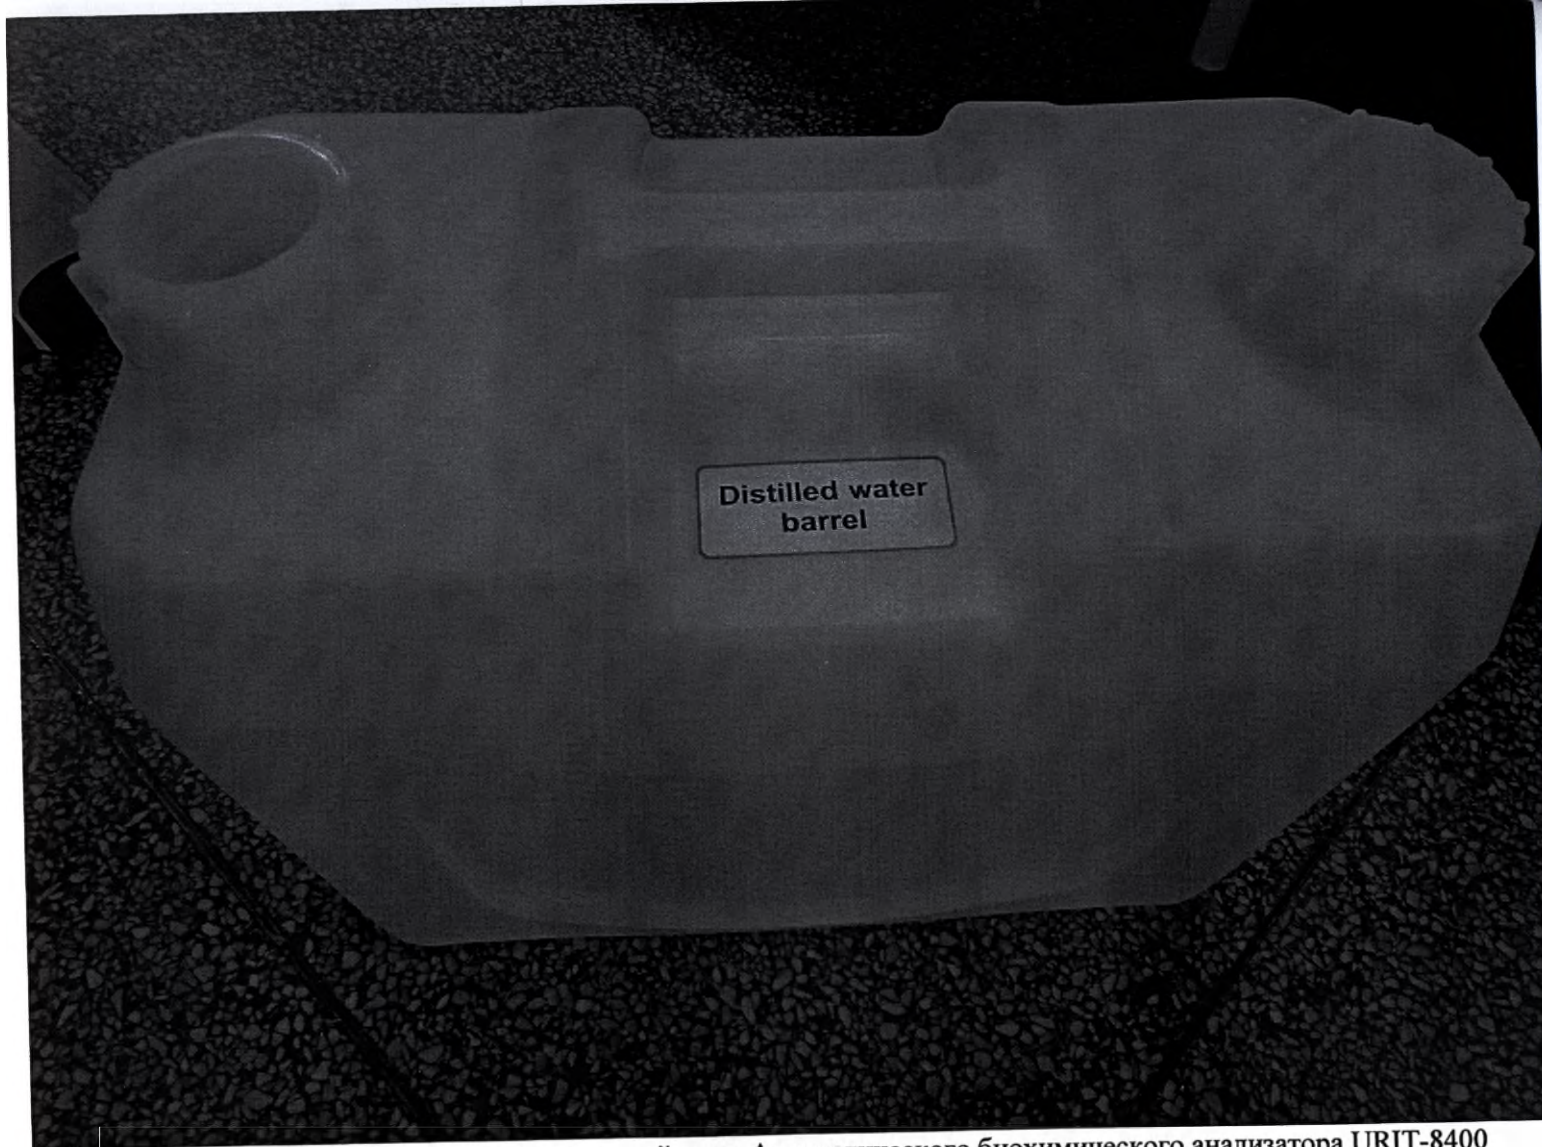


Рисунок 68 – Емкость для дистиллированной воды Автоматического биохимического анализатора URIT-8400

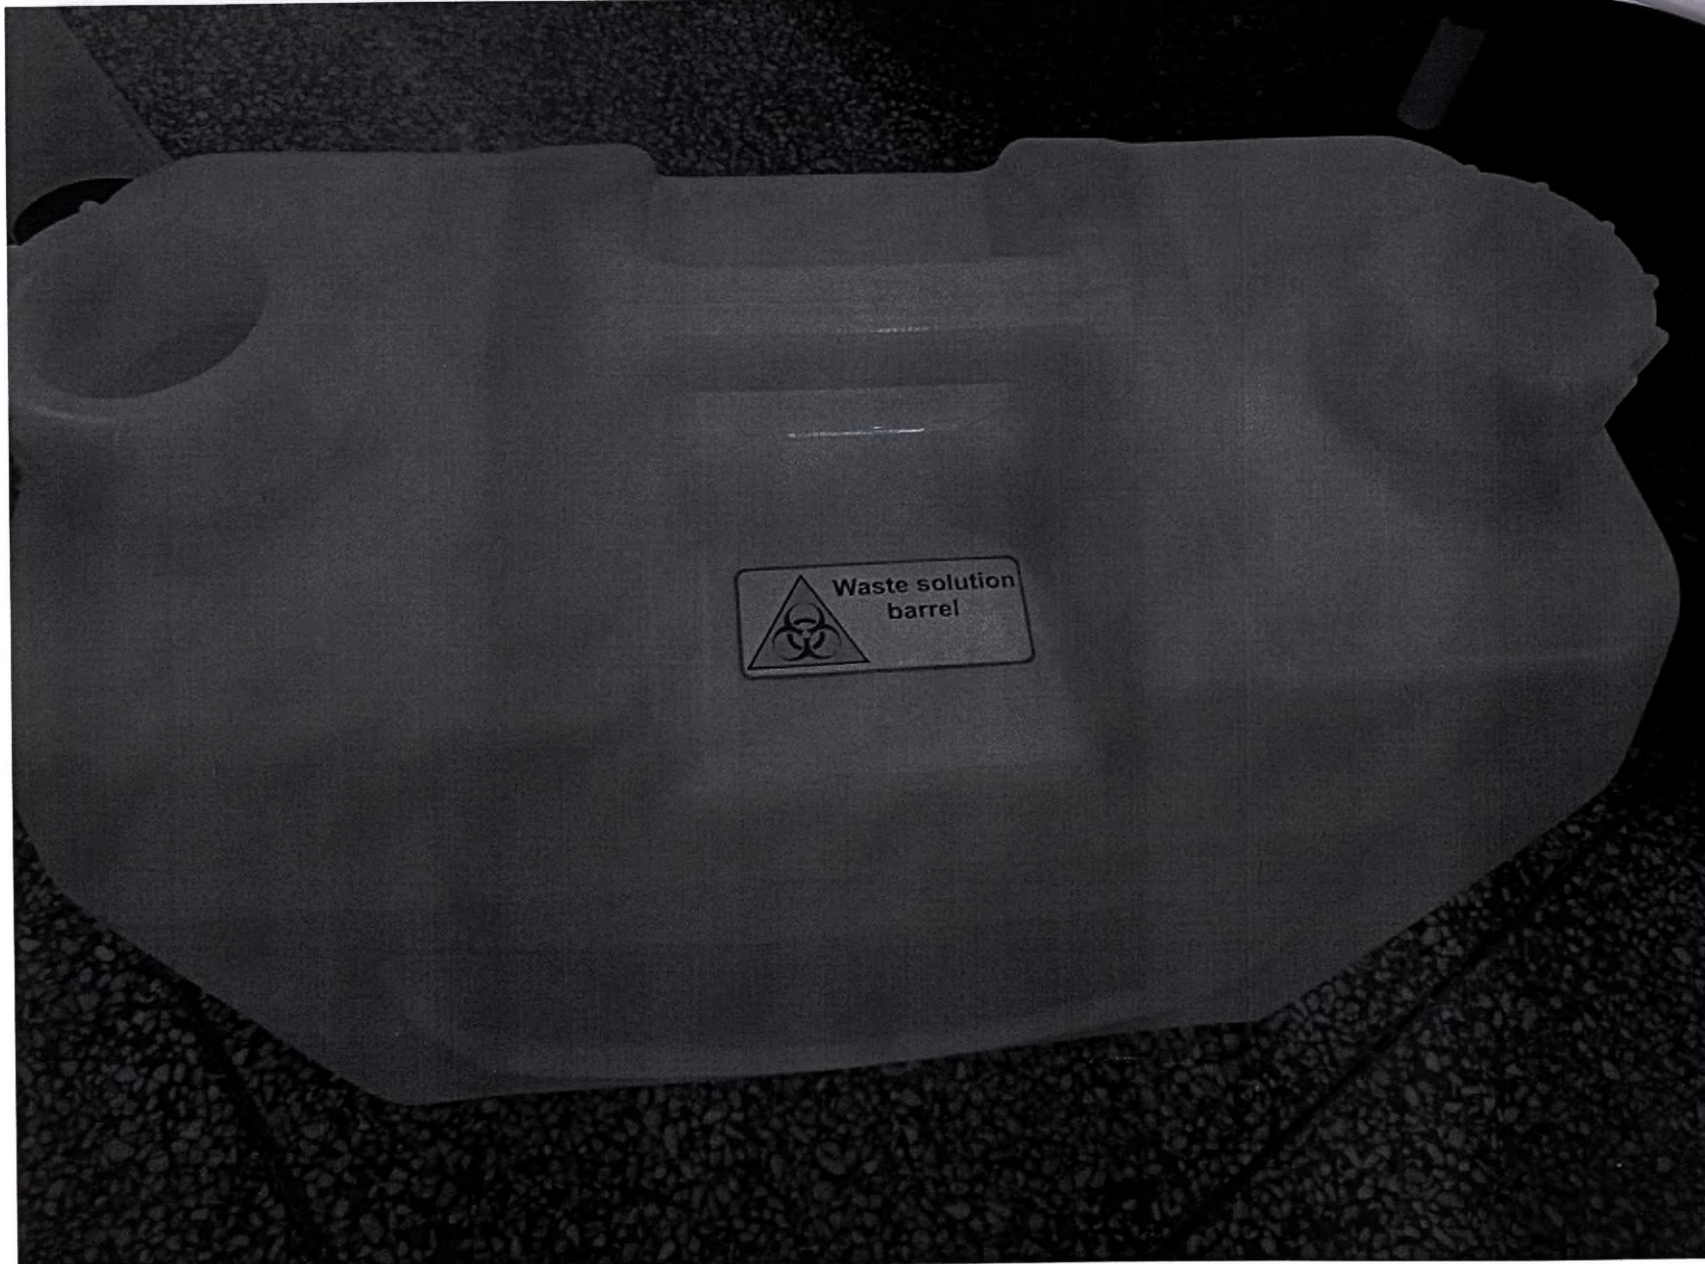

**Рисунок 69 – Емкость для слива отходов Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**

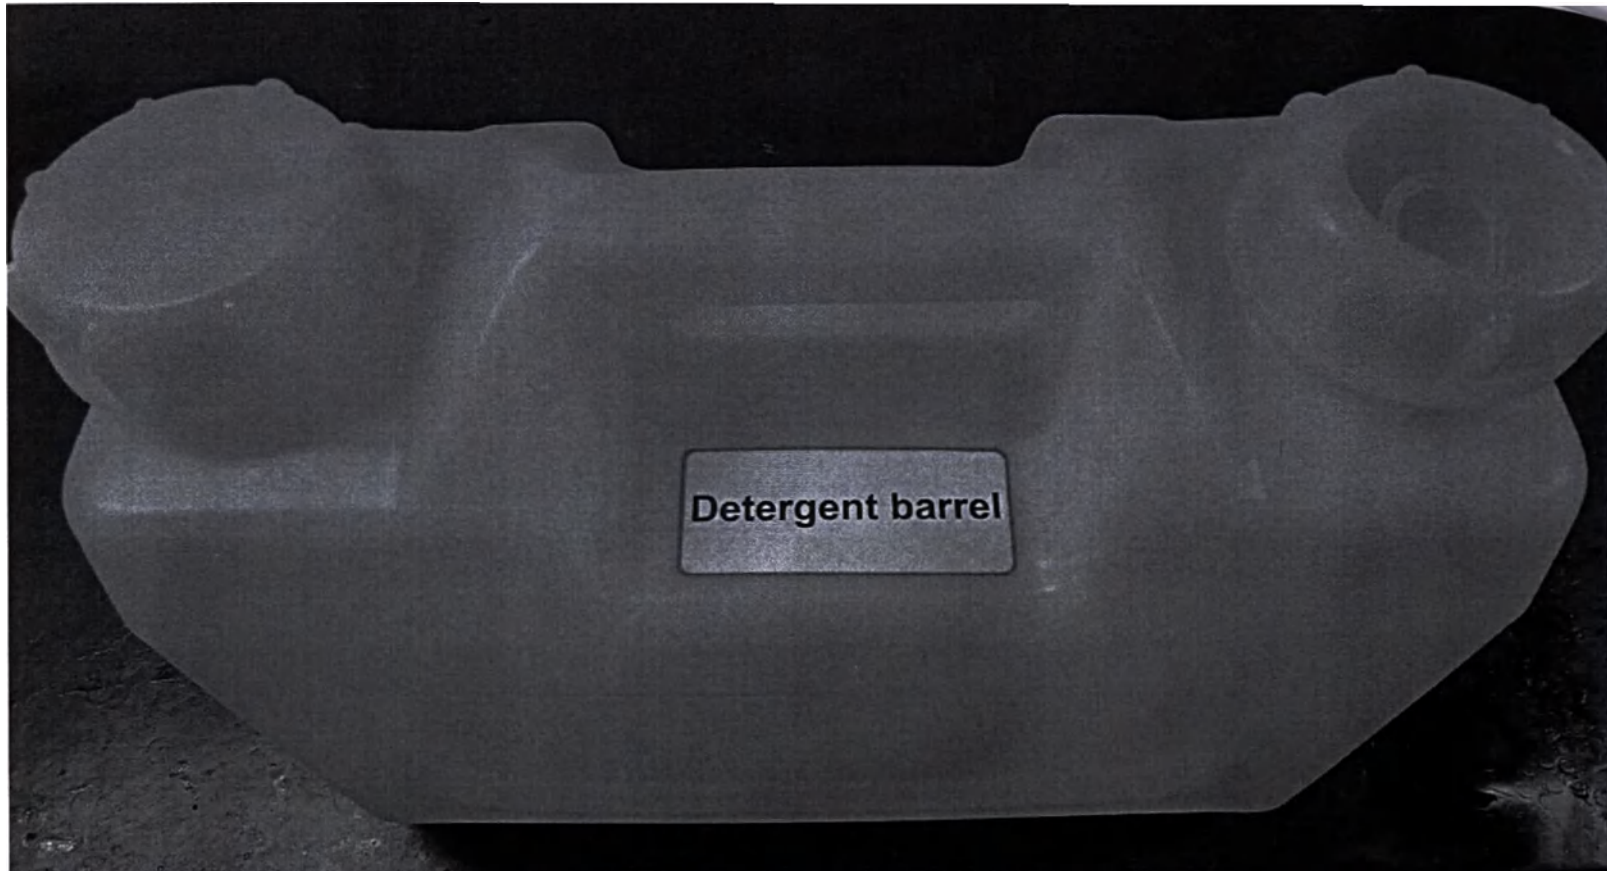

**Рисунок 70 – Емкость для детергента Автоматического биохимического анализатора URIT-8400**



Рисунок 71 – набор ключей шестигранных 1.5-4.0



Рисунок 72 – набор крестовых отверток

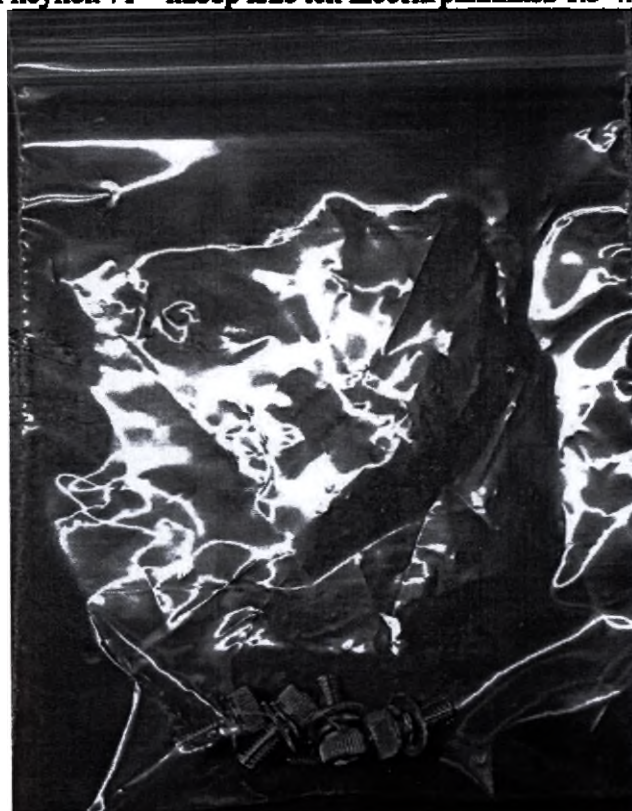


Рисунок 73 – Винт M2.5x6

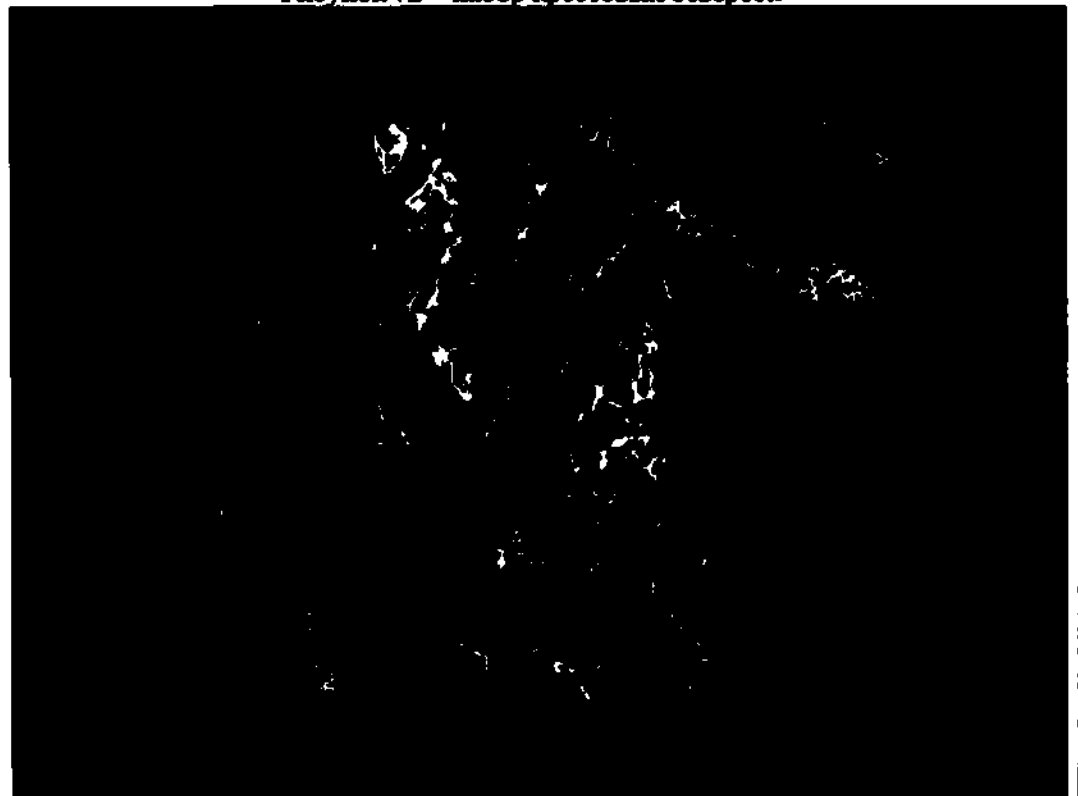


Рисунок 74 – Заглушка для отверстий



Рисунок 75 – Фильтр для воды

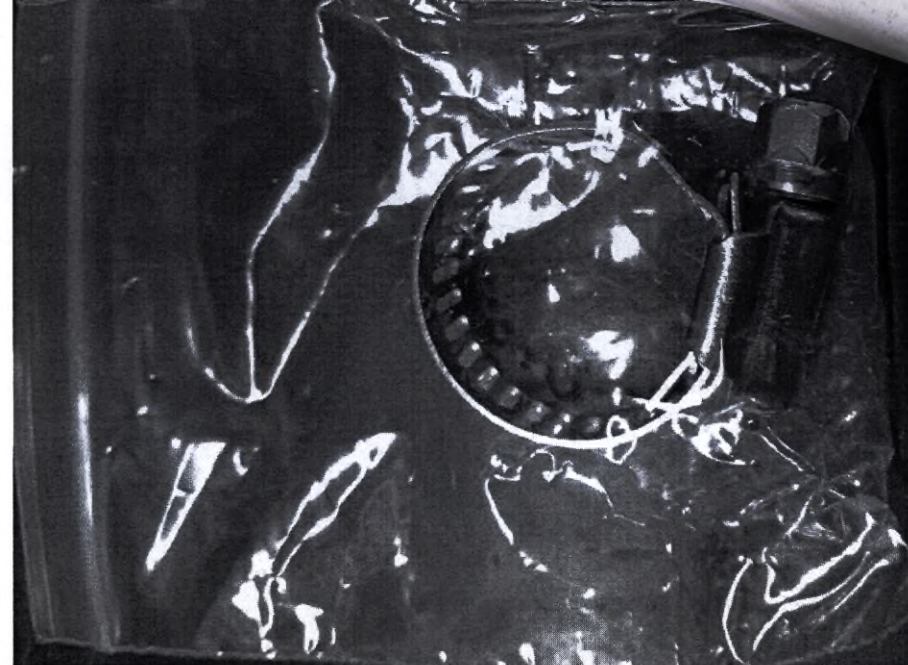


Рисунок 76 – Хомут

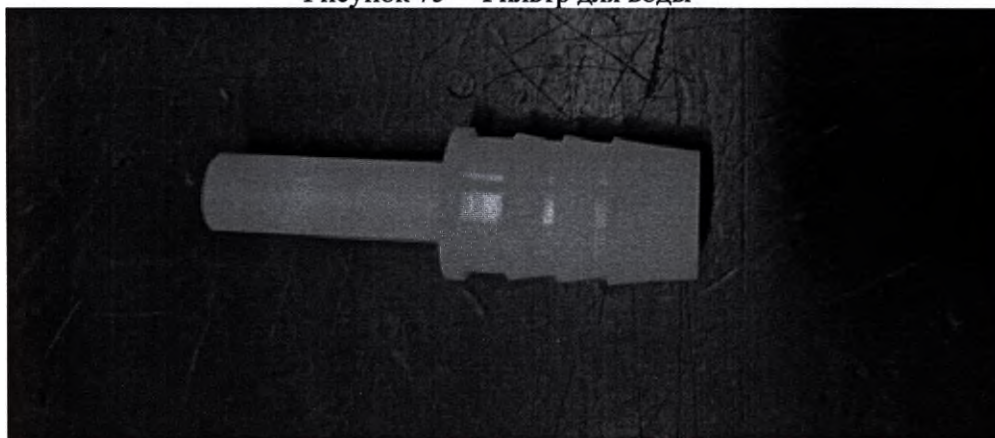


Рисунок 77 – 3/8 быстроразъемный штекер 1/4

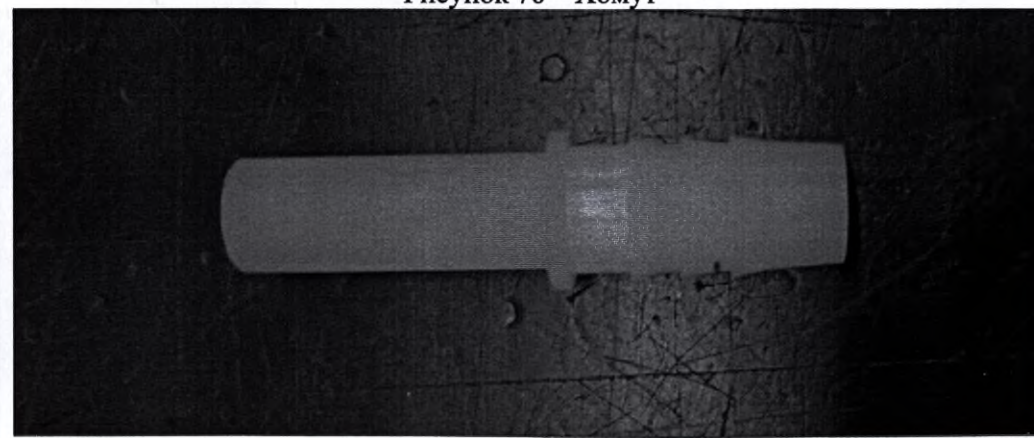


Рисунок 78 – 3/8 быстроразъемный штекер 3/8

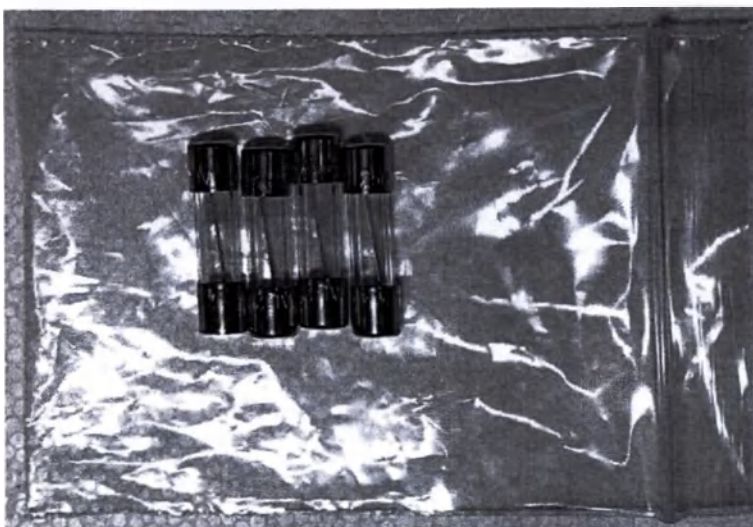


Рисунок 79 – Предохранитель Автоматического биохимического анализатора URIT-8400



Рисунок 80 – Мандрен для прочистки зонда

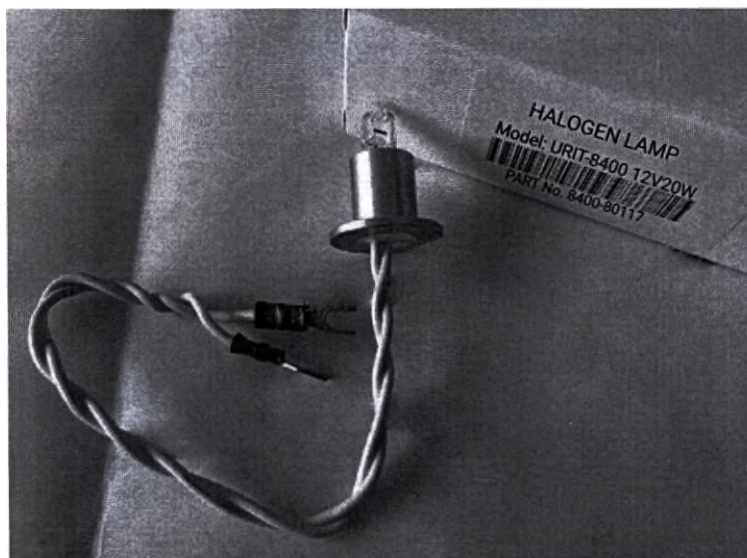


Рисунок 81 – Галогенная лампа 12 В/20 Вт



Рисунок 82 – Абразивная бумага

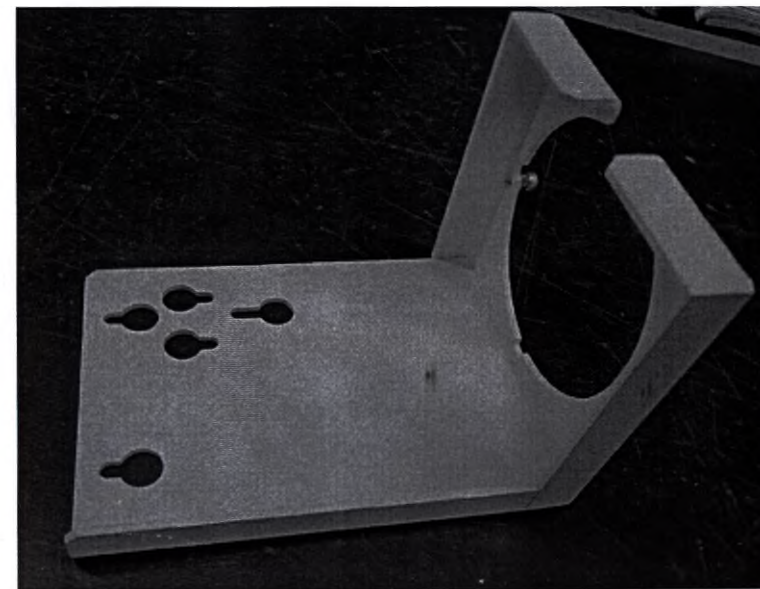


Рисунок 83 – Держатель металлический

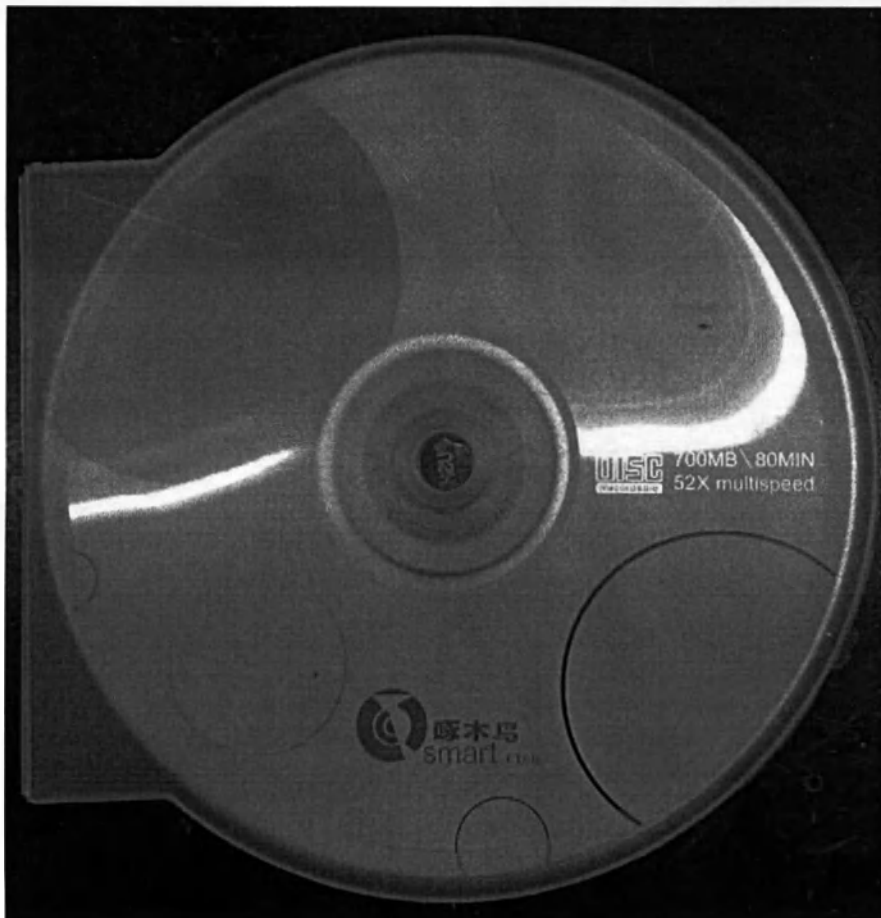


Рисунок 84 – CD-диск для установки программного обеспечения Автоматического биохимического анализатора URIT-8400

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью ( серия 111111 ) листов  
Директор ООО «КРАФТ»  
/С.И. Барышников/  
2021 г.

