

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»



Н.Н. Перцева


«27» августа 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Набор реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека (DHEA-S CLIA Microparticles (DHEA-S)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов




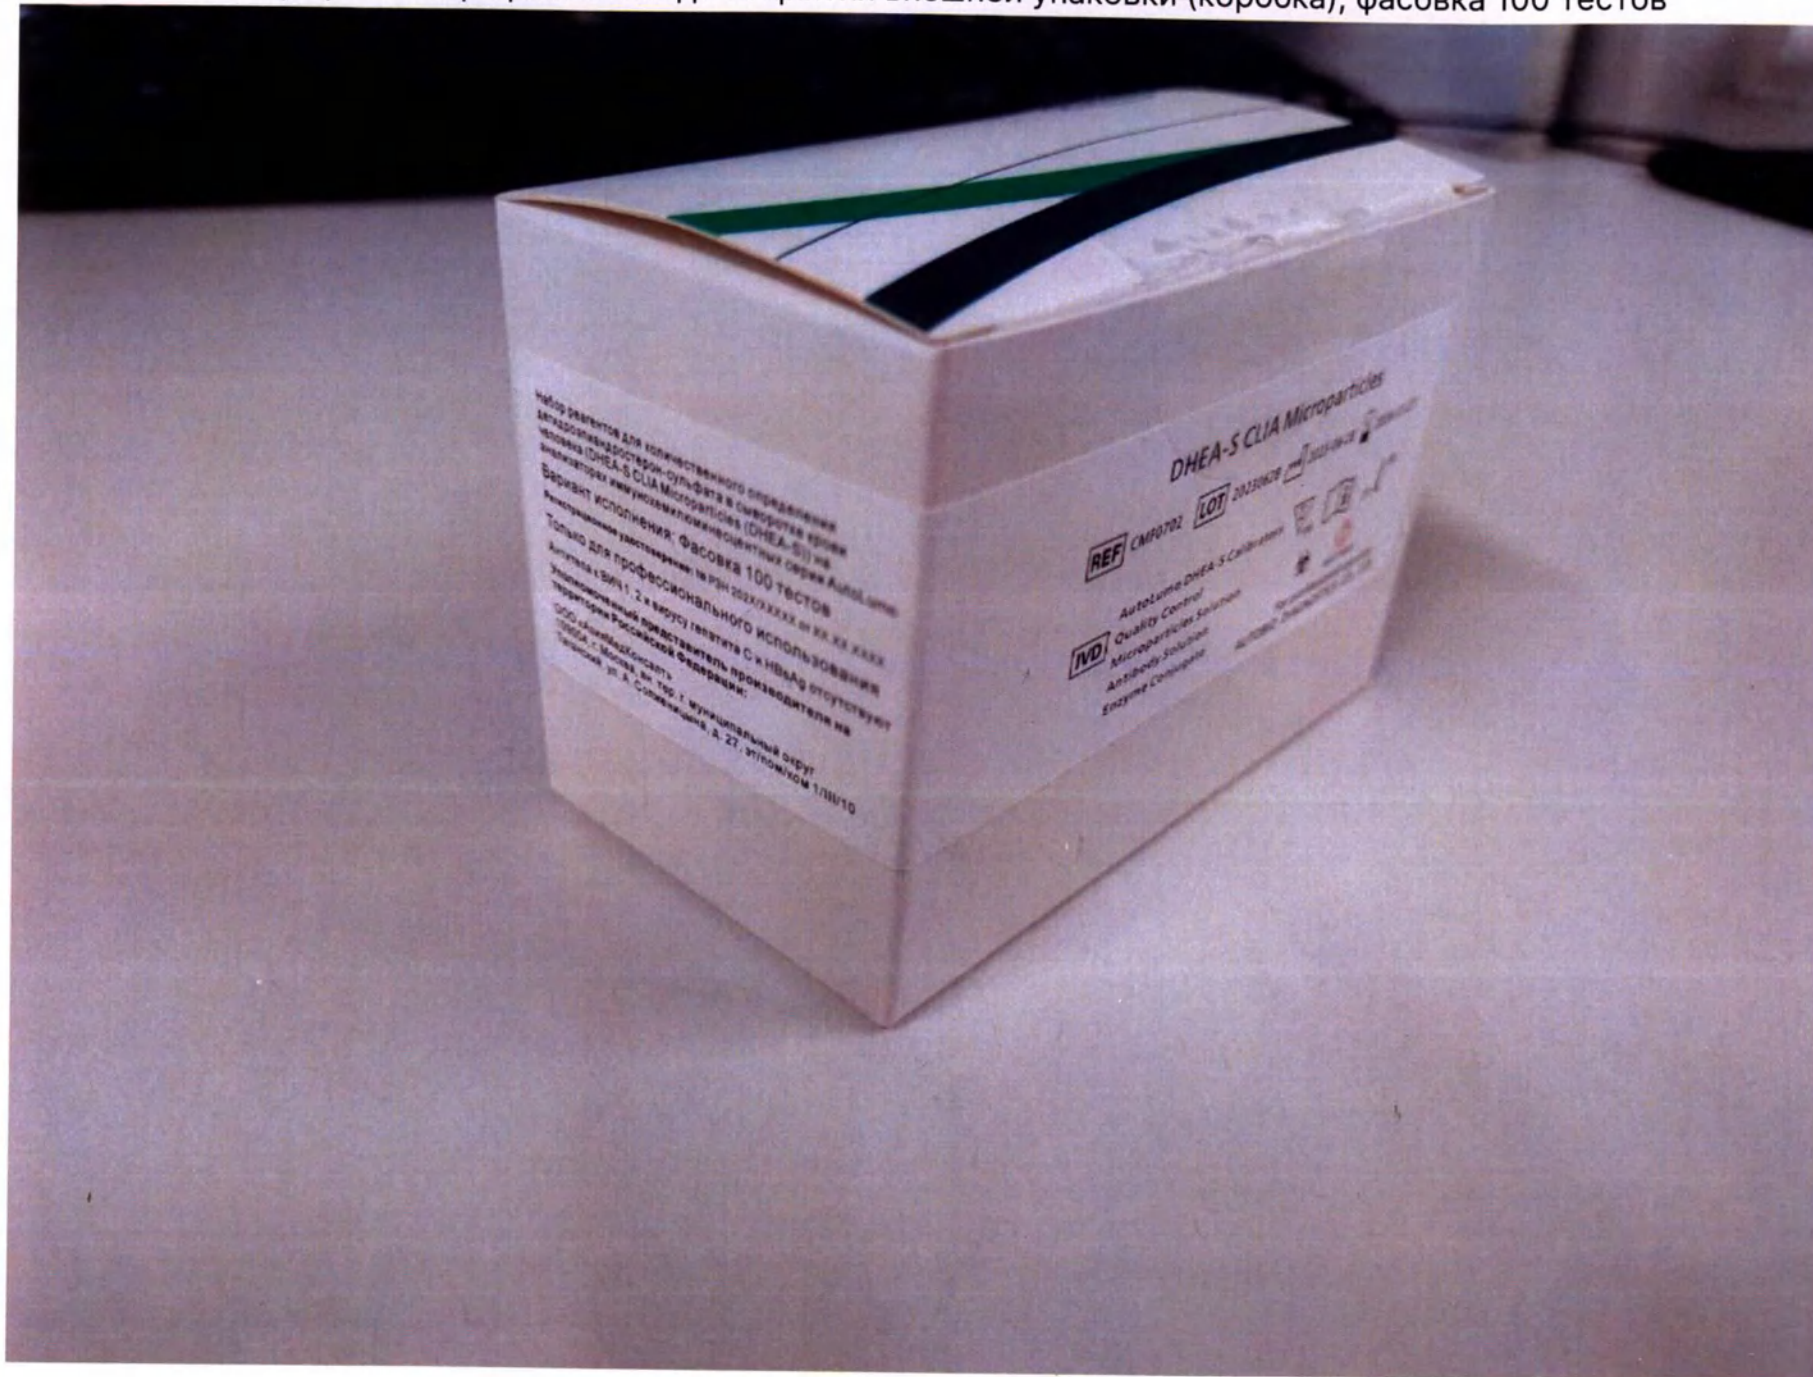

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100*2 тестов

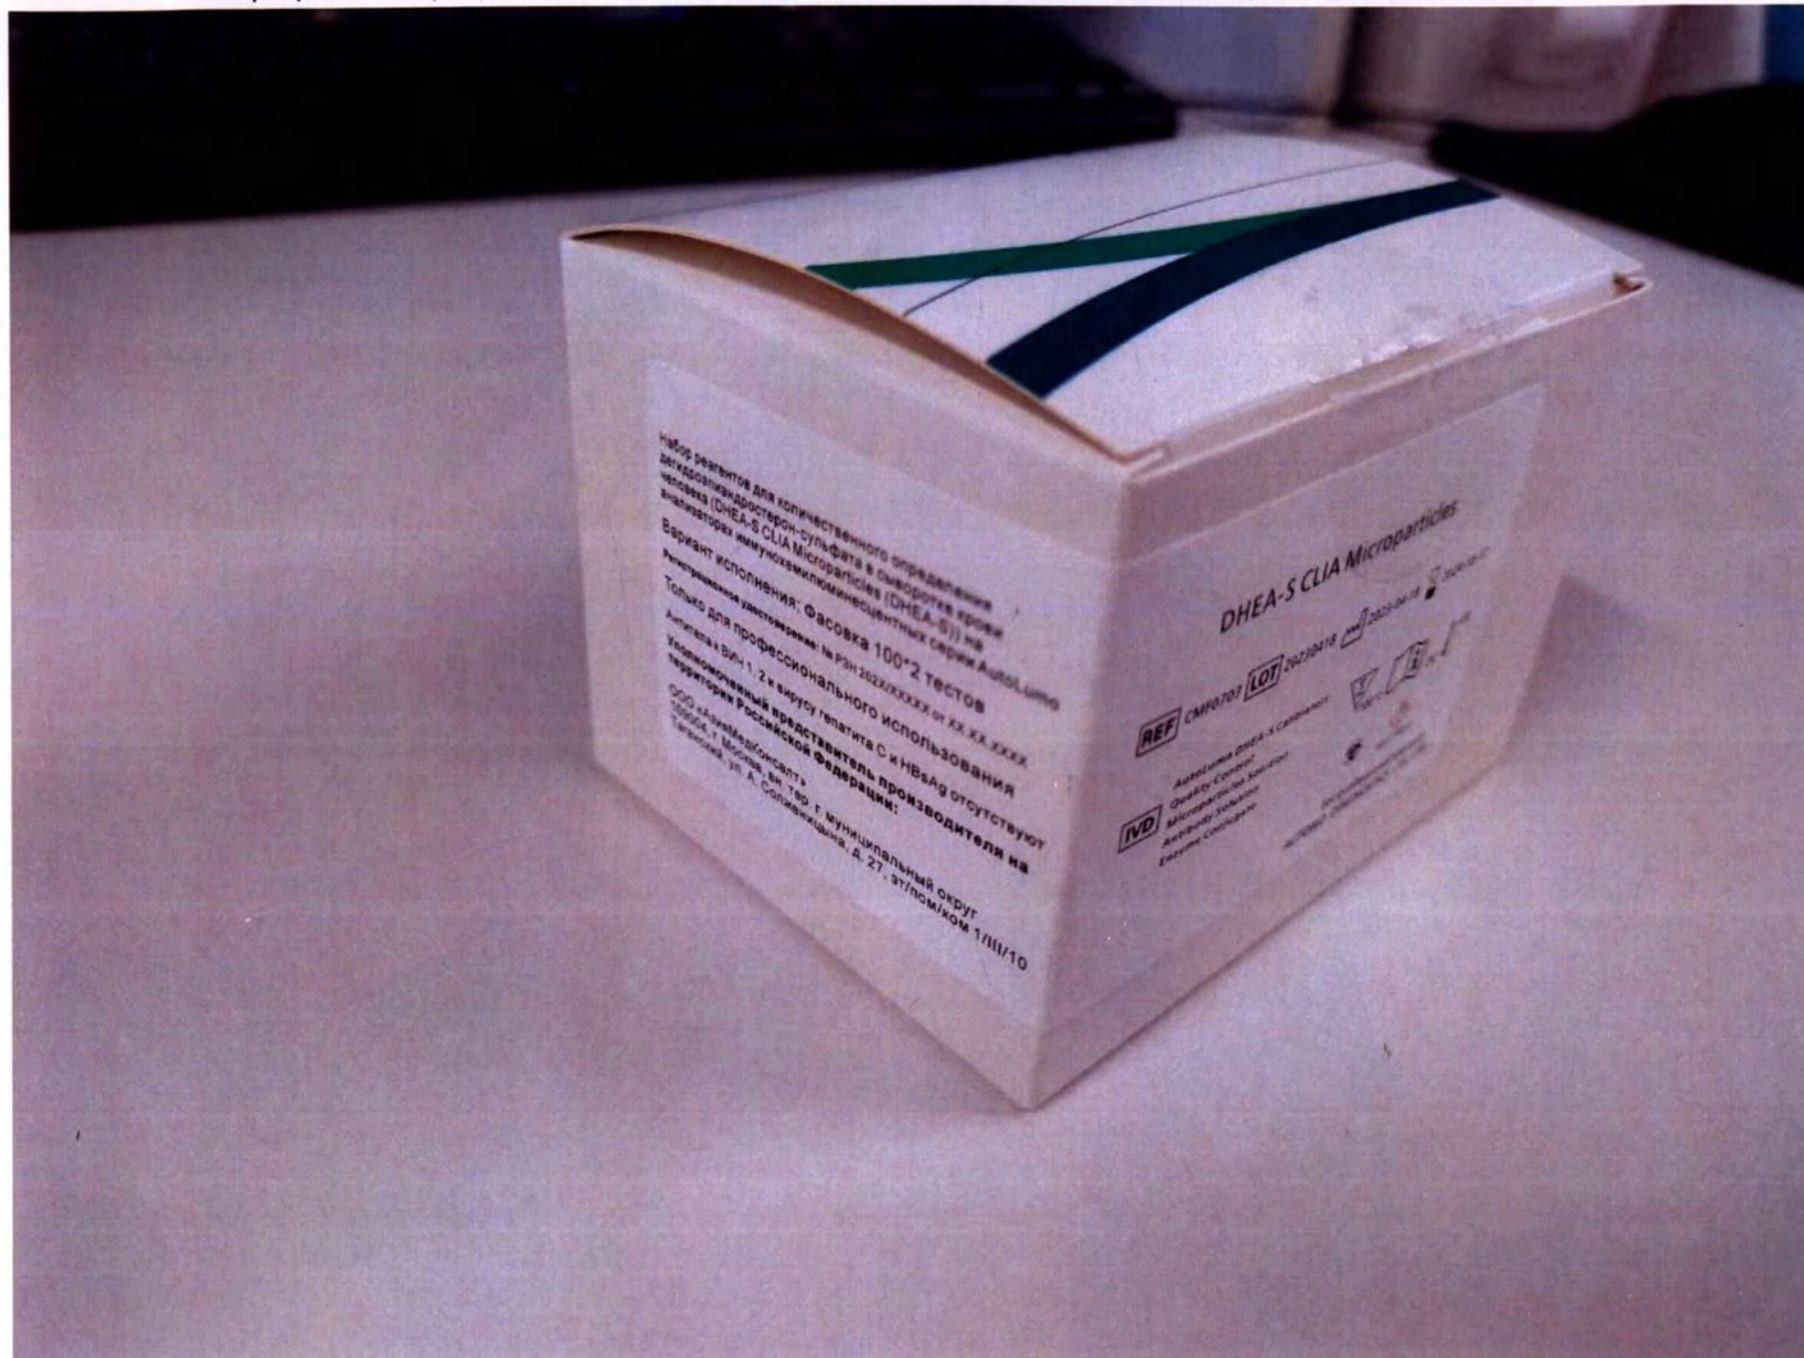

Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 50*2 тестов

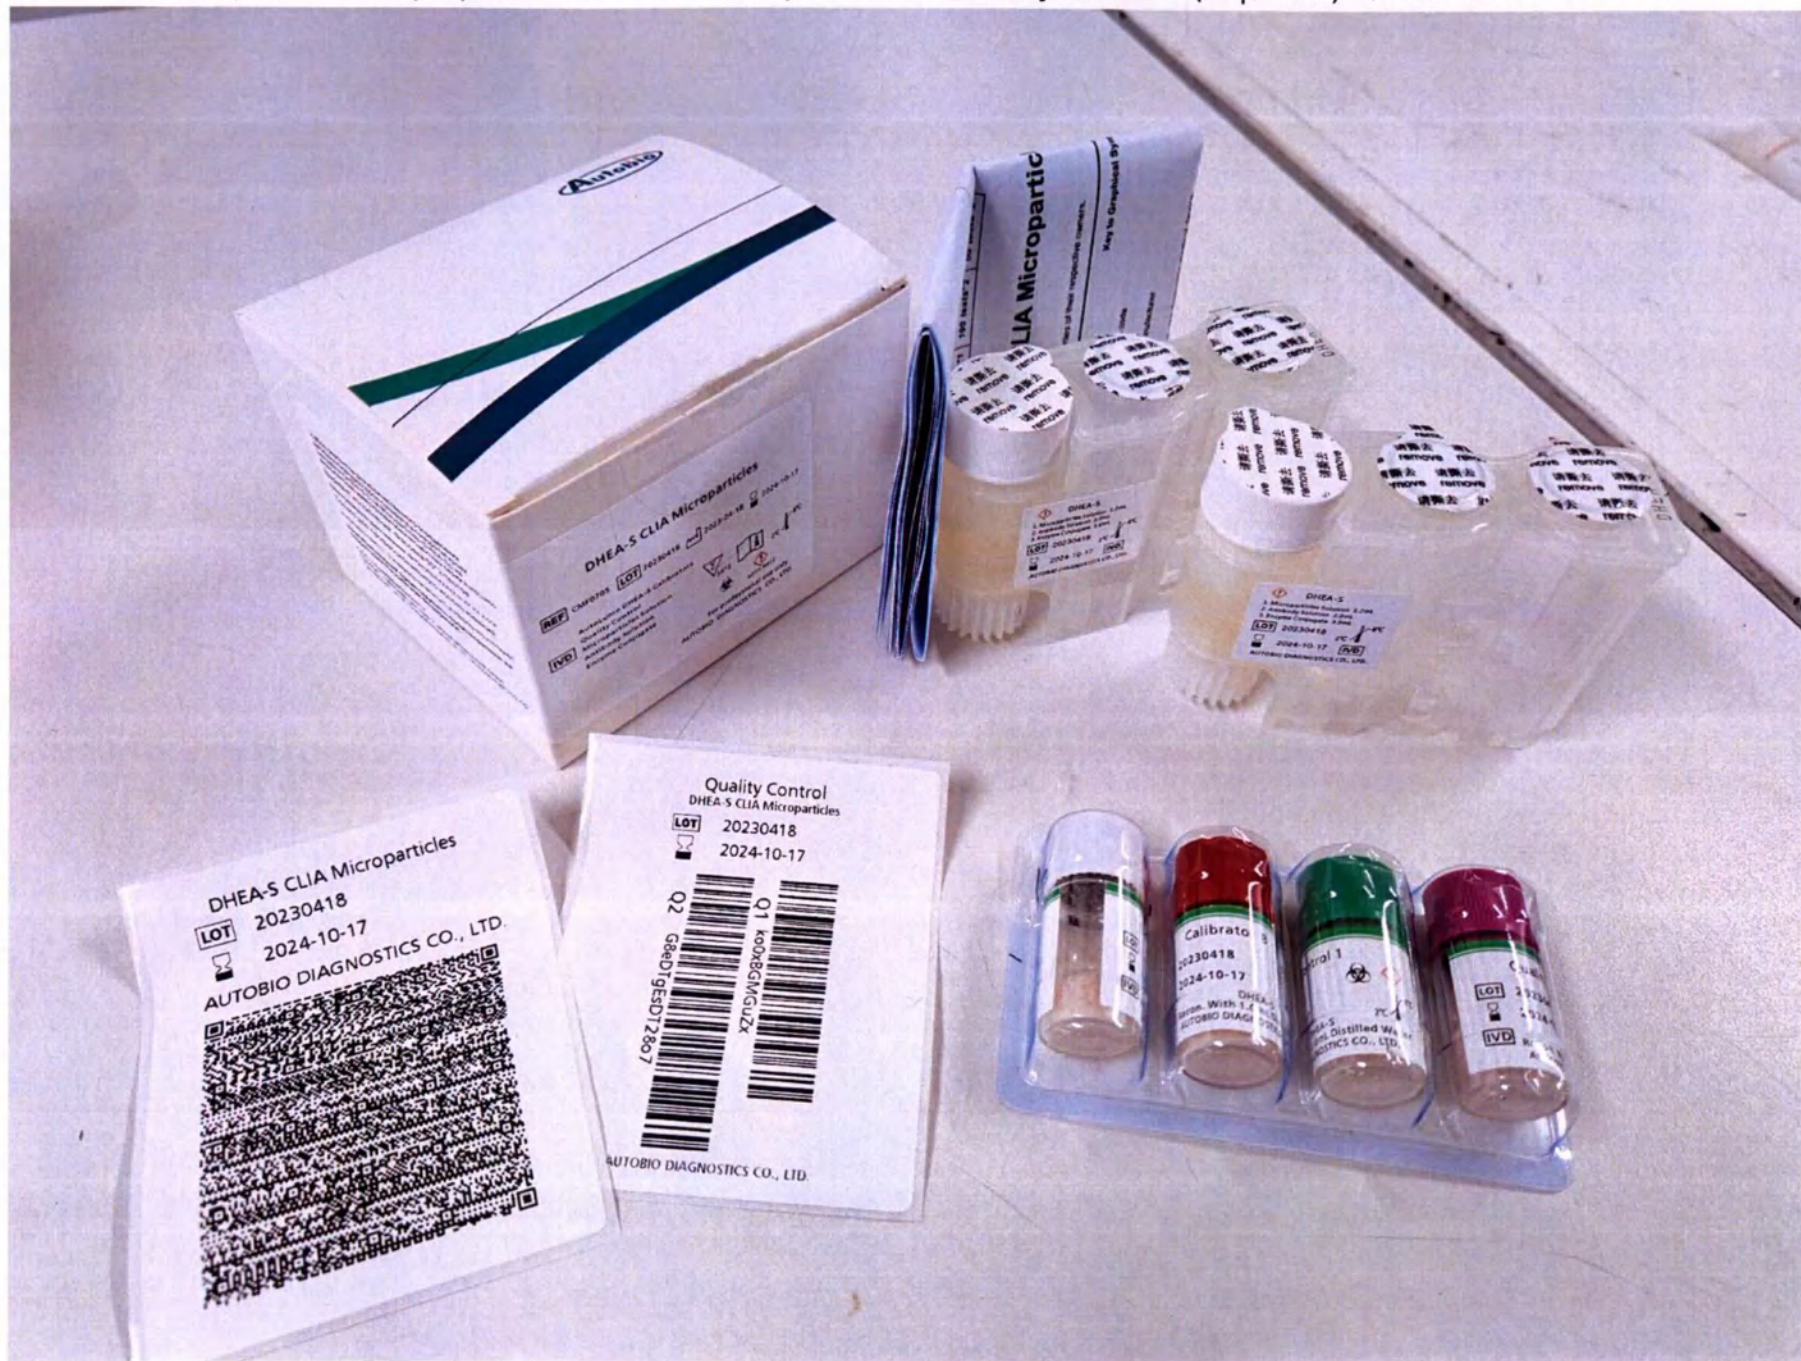


Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов




Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*2 тестов



Варианты картриджей

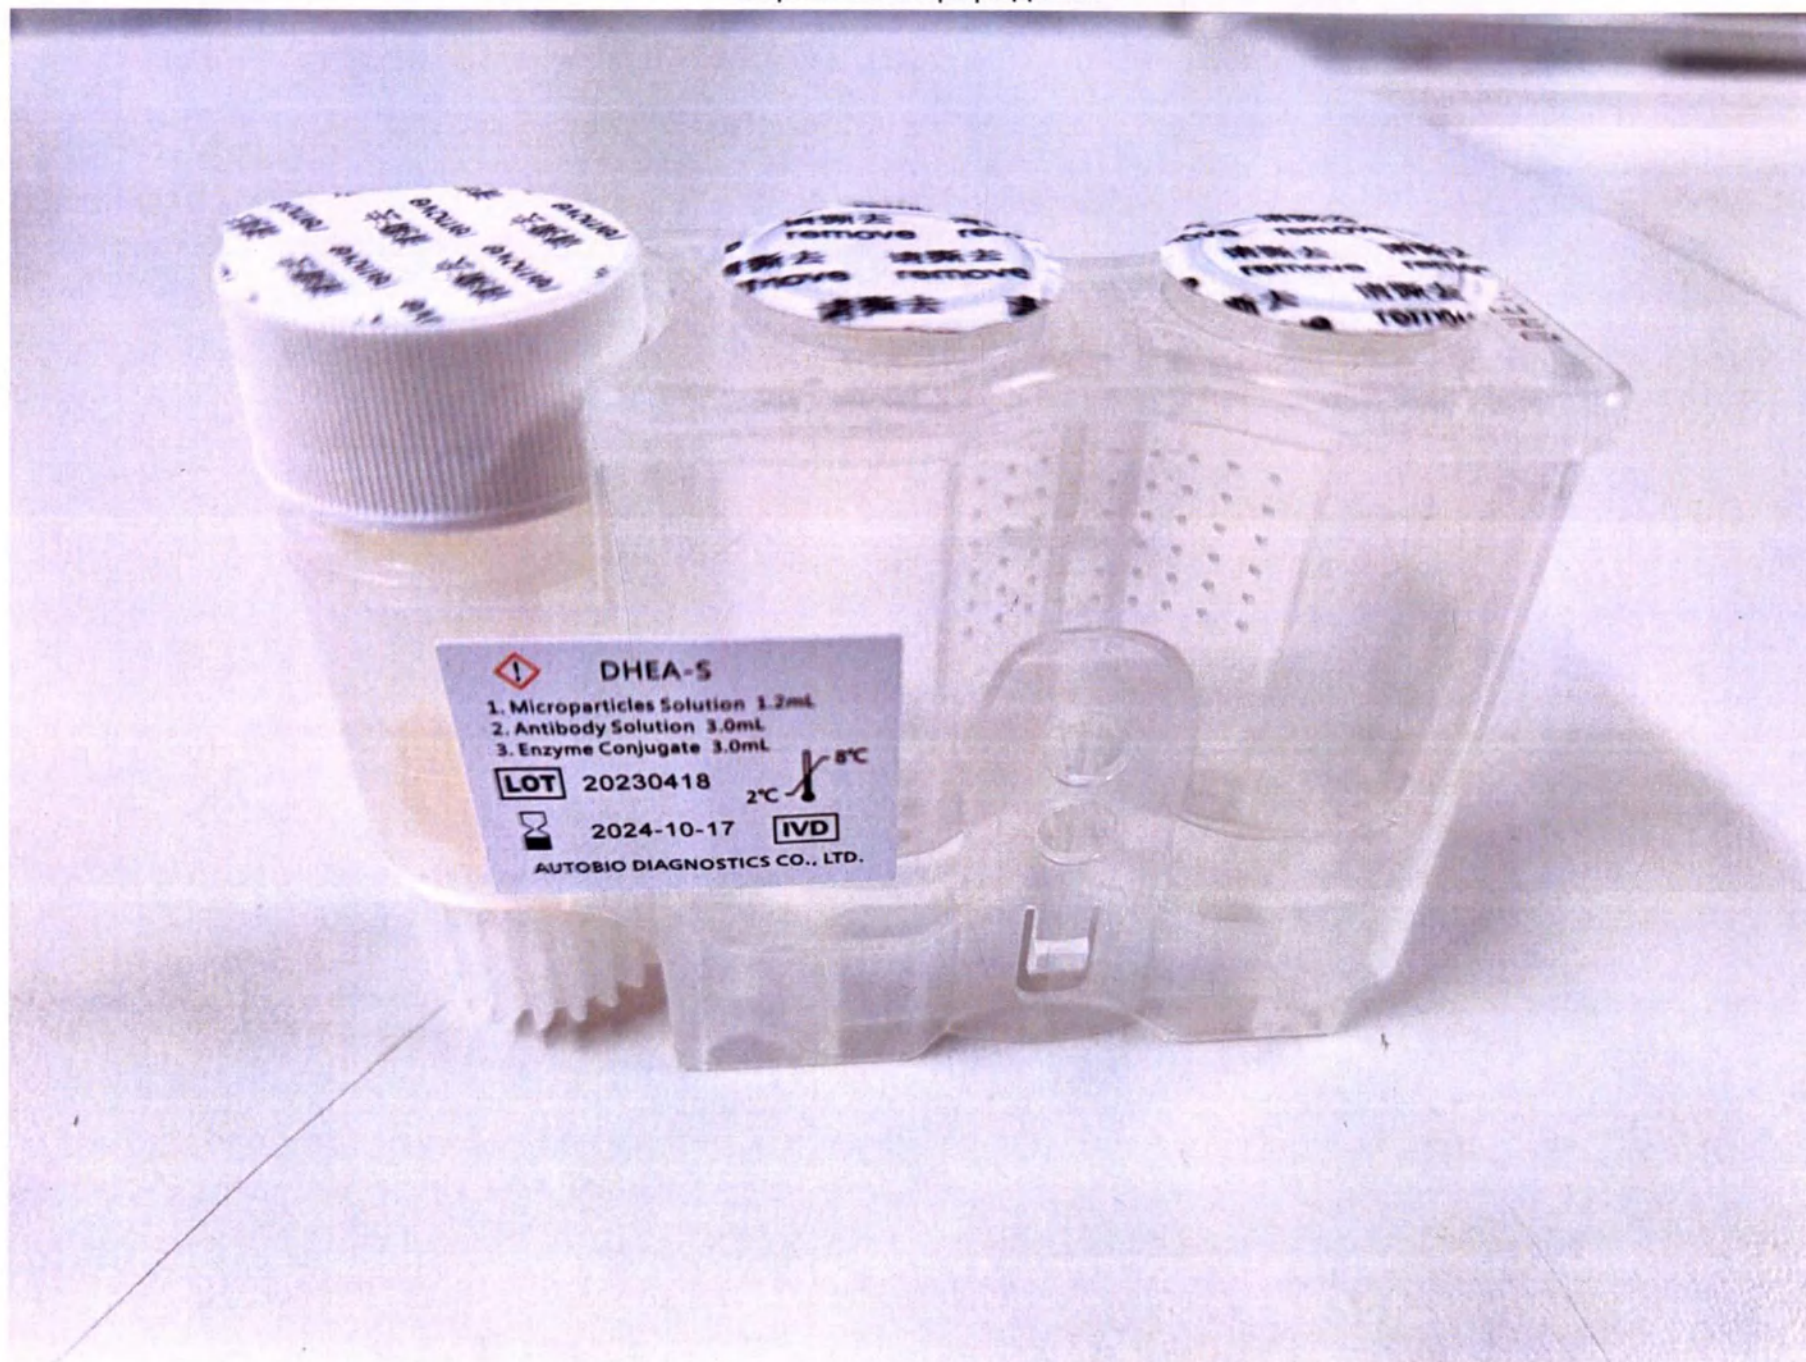



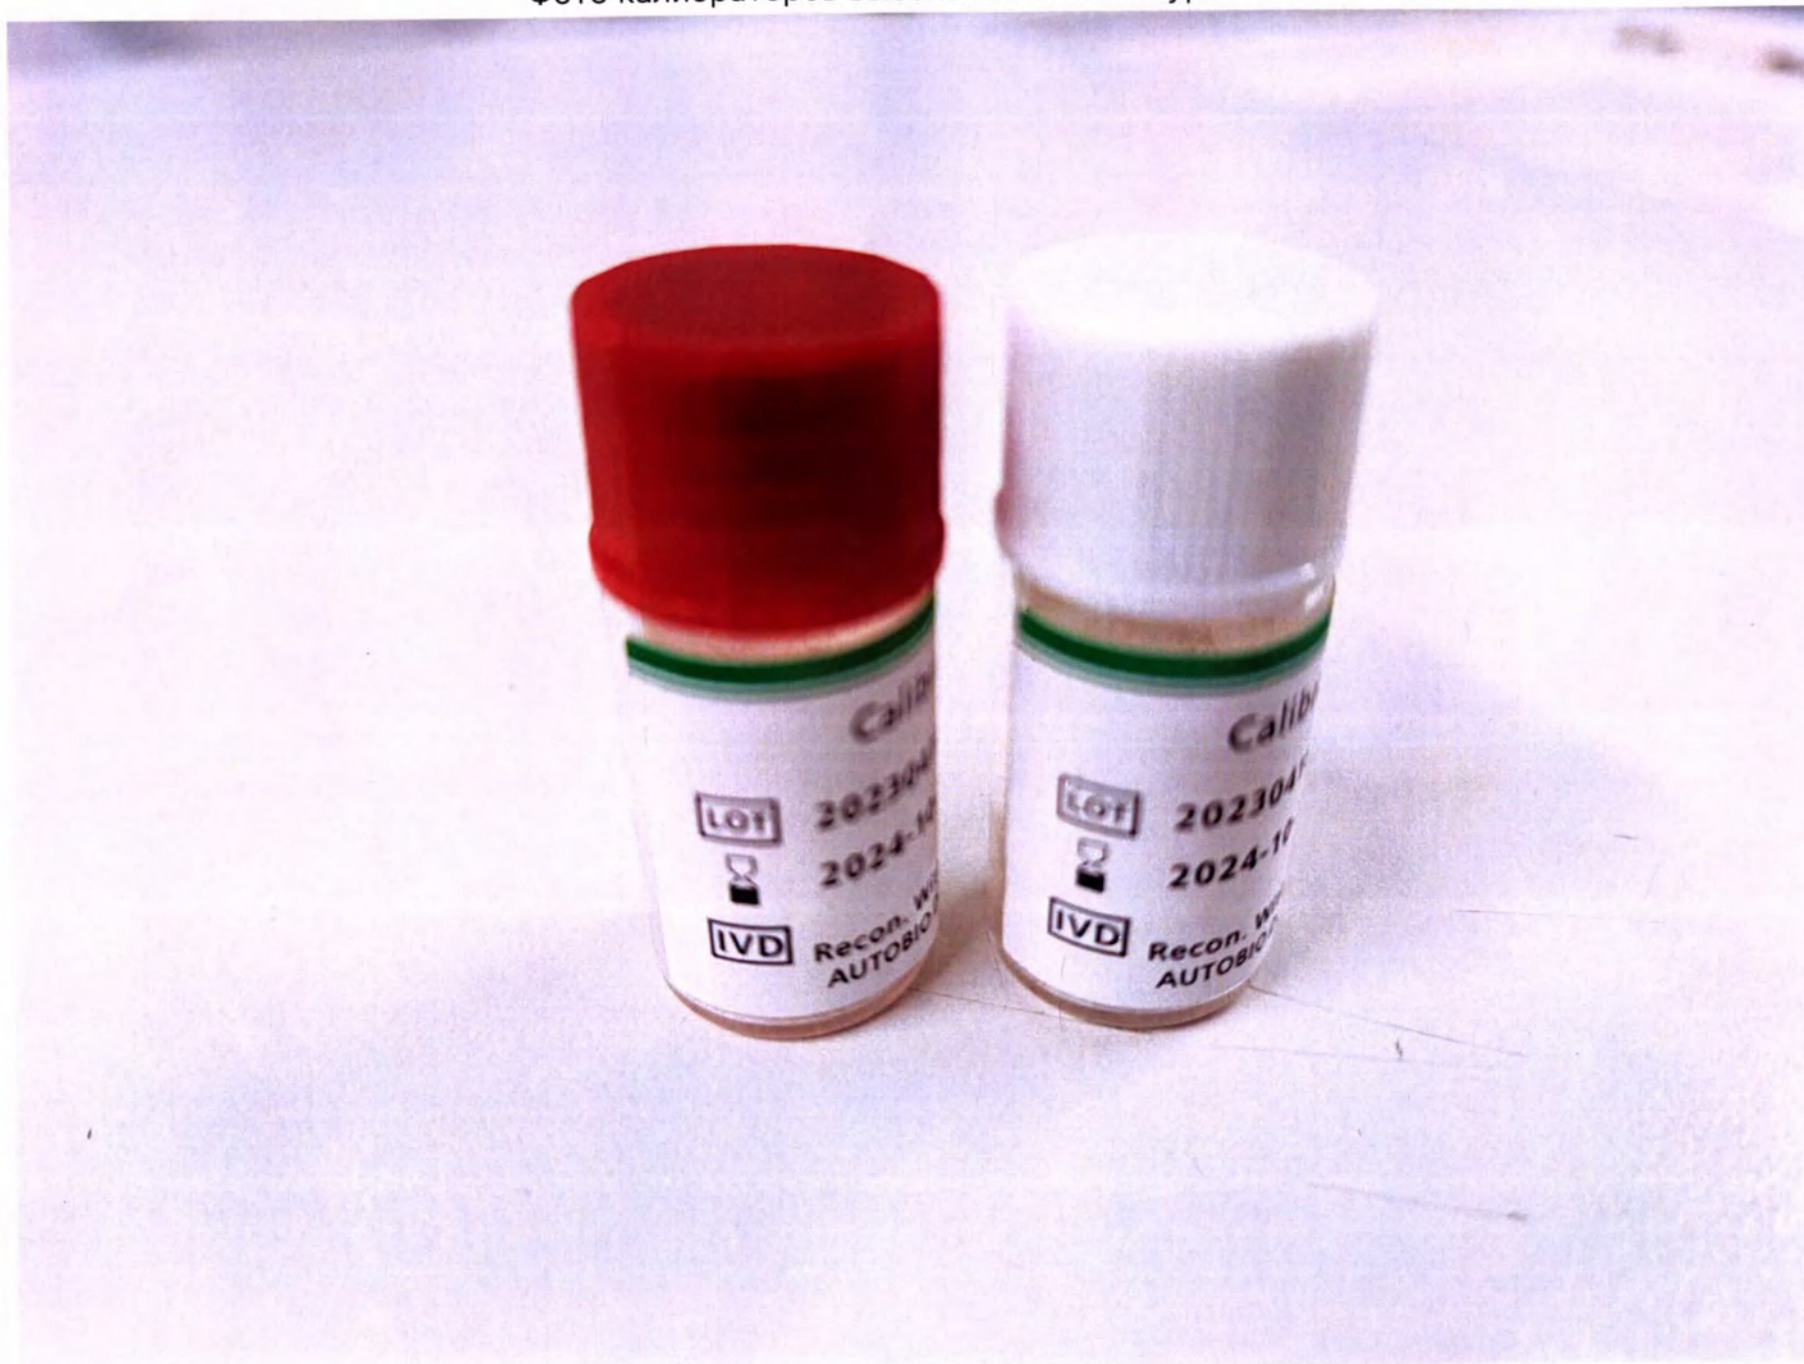











Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Макеты русскоязычной маркировки

Набор реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека (DHEA-S CLIA Microparticles (DHEA-S)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

DHEA-S CLIA Microparticles

REF CMF0705

LOT



IVD

AutoLumo DHEA-S Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Antibody Solution
Enzyme Conjugate



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека (DHEA-S CLIA Microparticles (DHEA-S)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

DHEA-S CLIA Microparticles

REF CMF0702

LOT



IVD

AutoLumo DHEA-S Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Antibody Solution
Enzyme Conjugate



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека (DHEA-S CLIA Microparticles (DHEA-S)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

DHEA-S CLIA Microparticles

REF CMF0703

LOT



IVD

AutoLumo DHEA-S Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Antibody Solution
Enzyme Conjugate



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 17
семнадцати листах