

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»




Перцева Н. Н.


«26» августа 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и
плазме крови человека (E2 CLIA Microparticles (E2)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo.



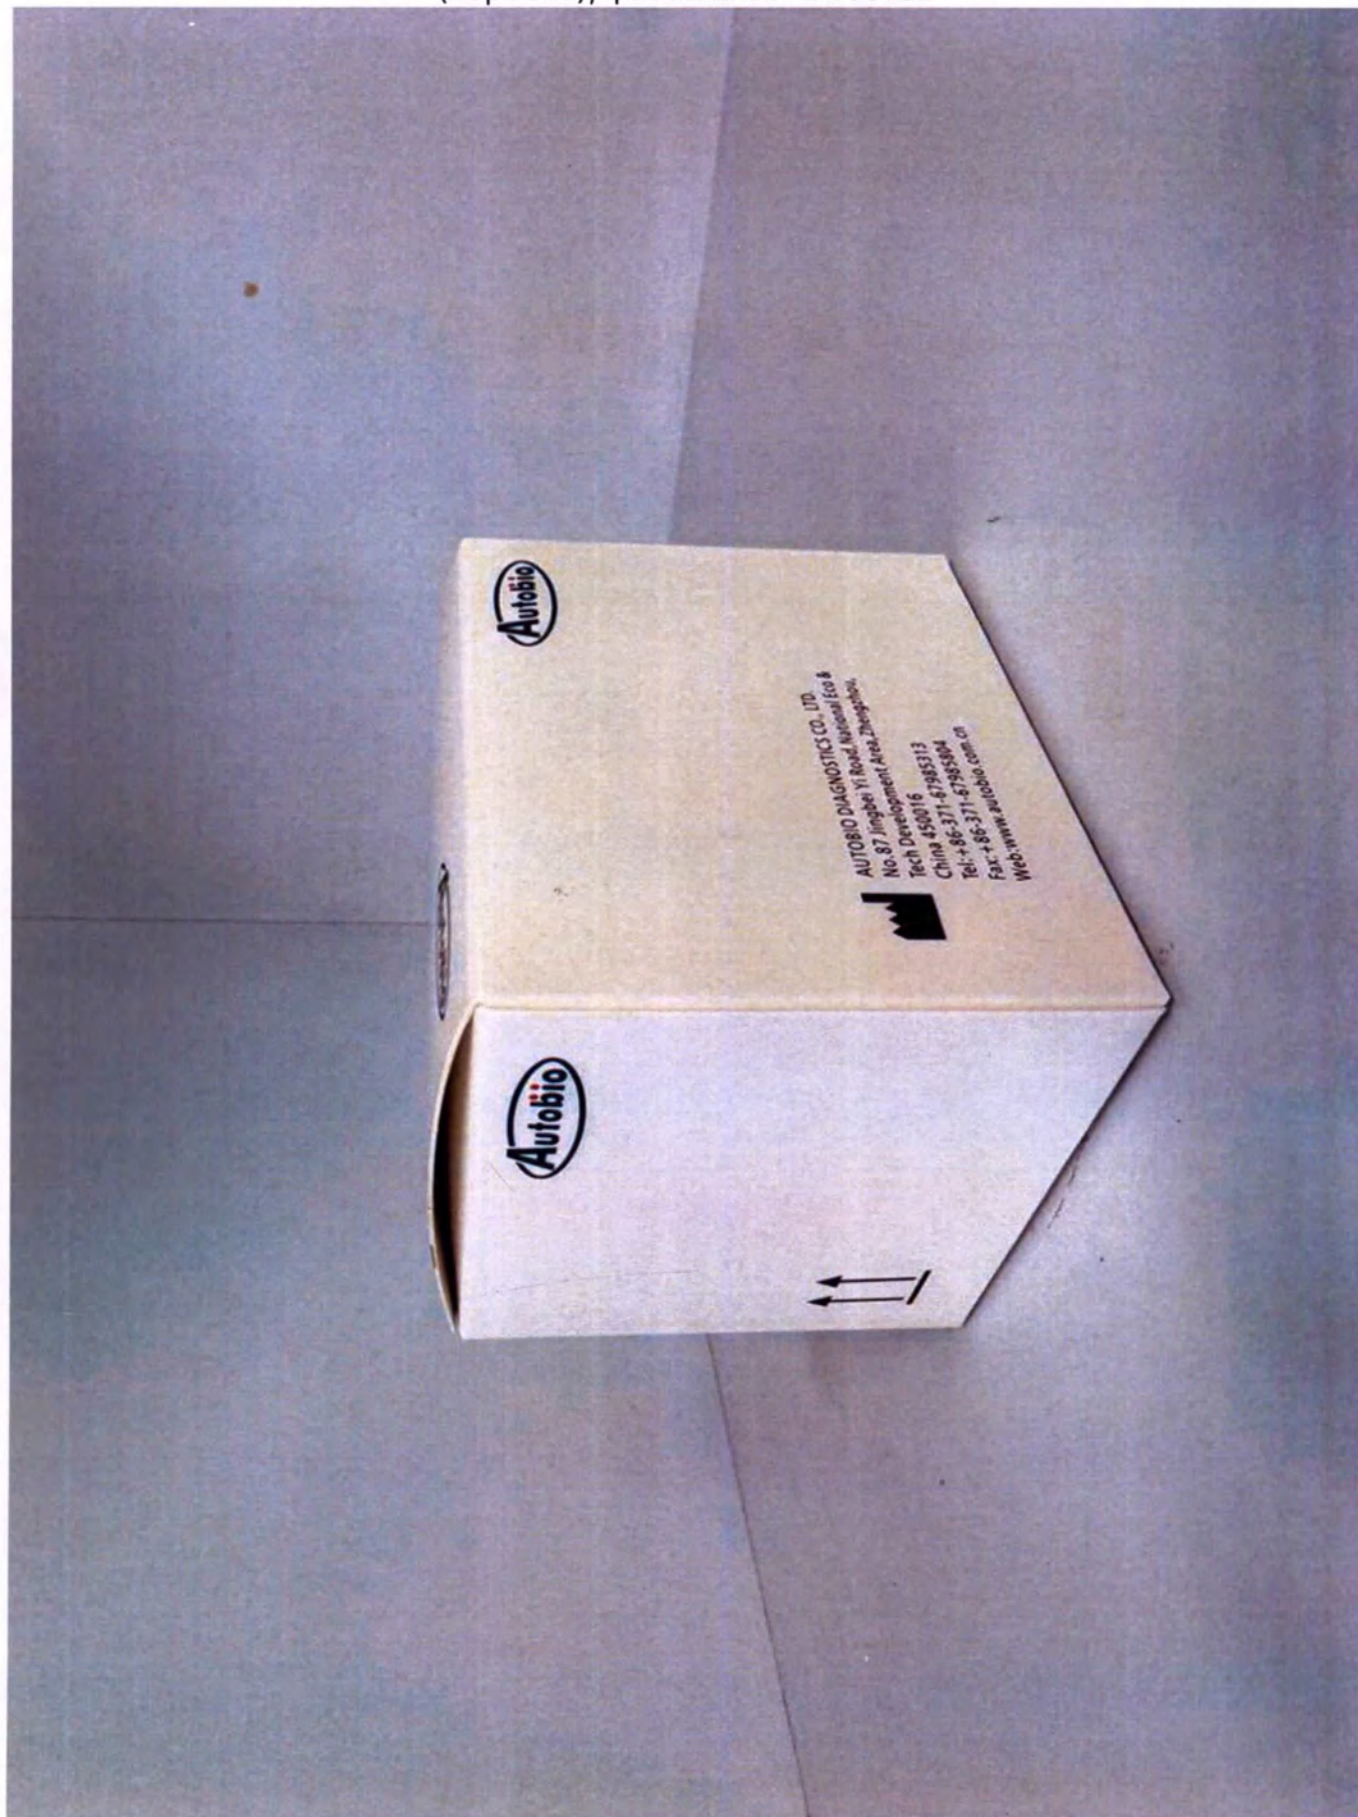

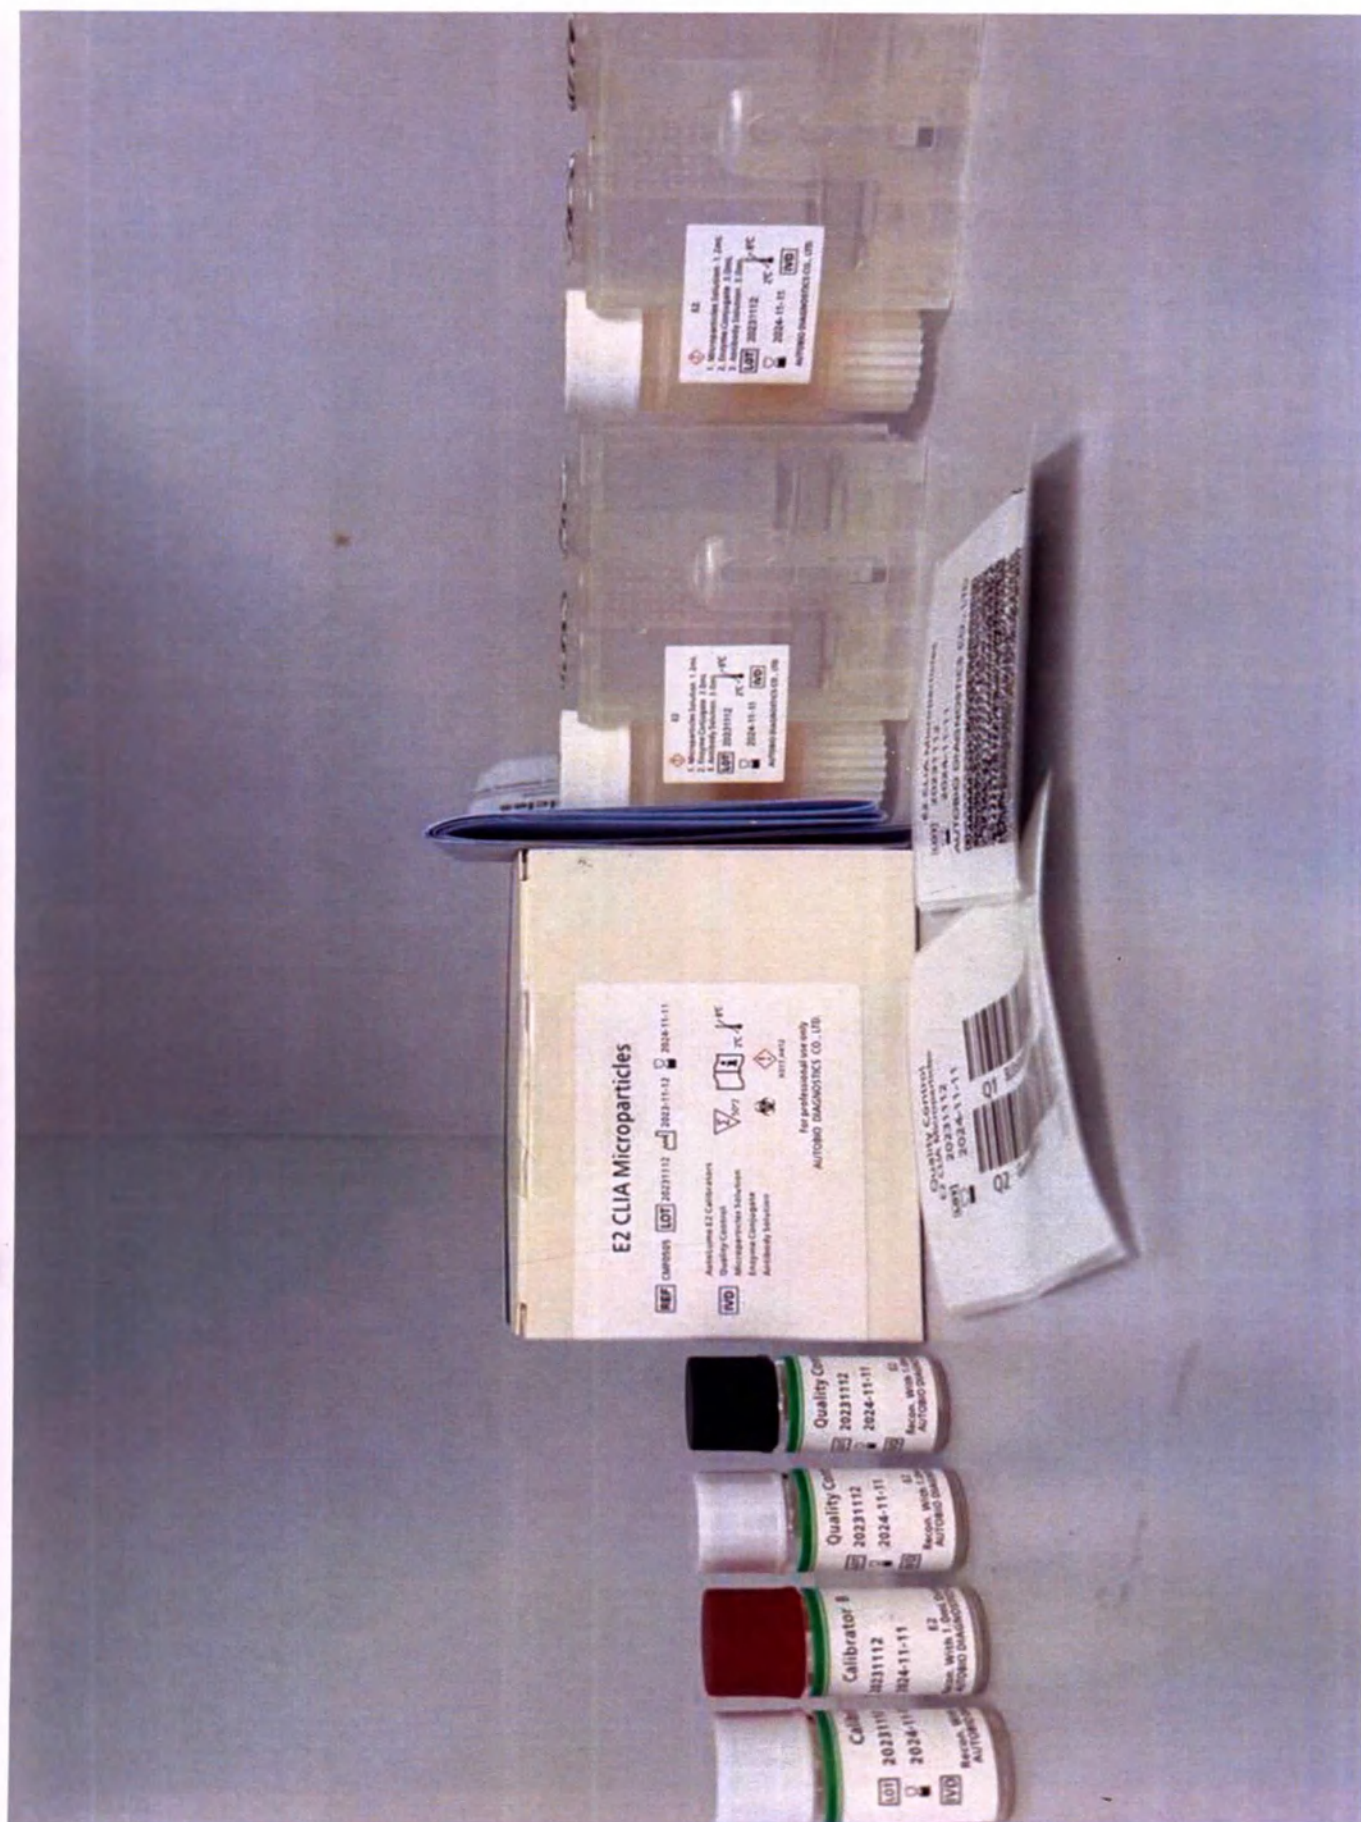



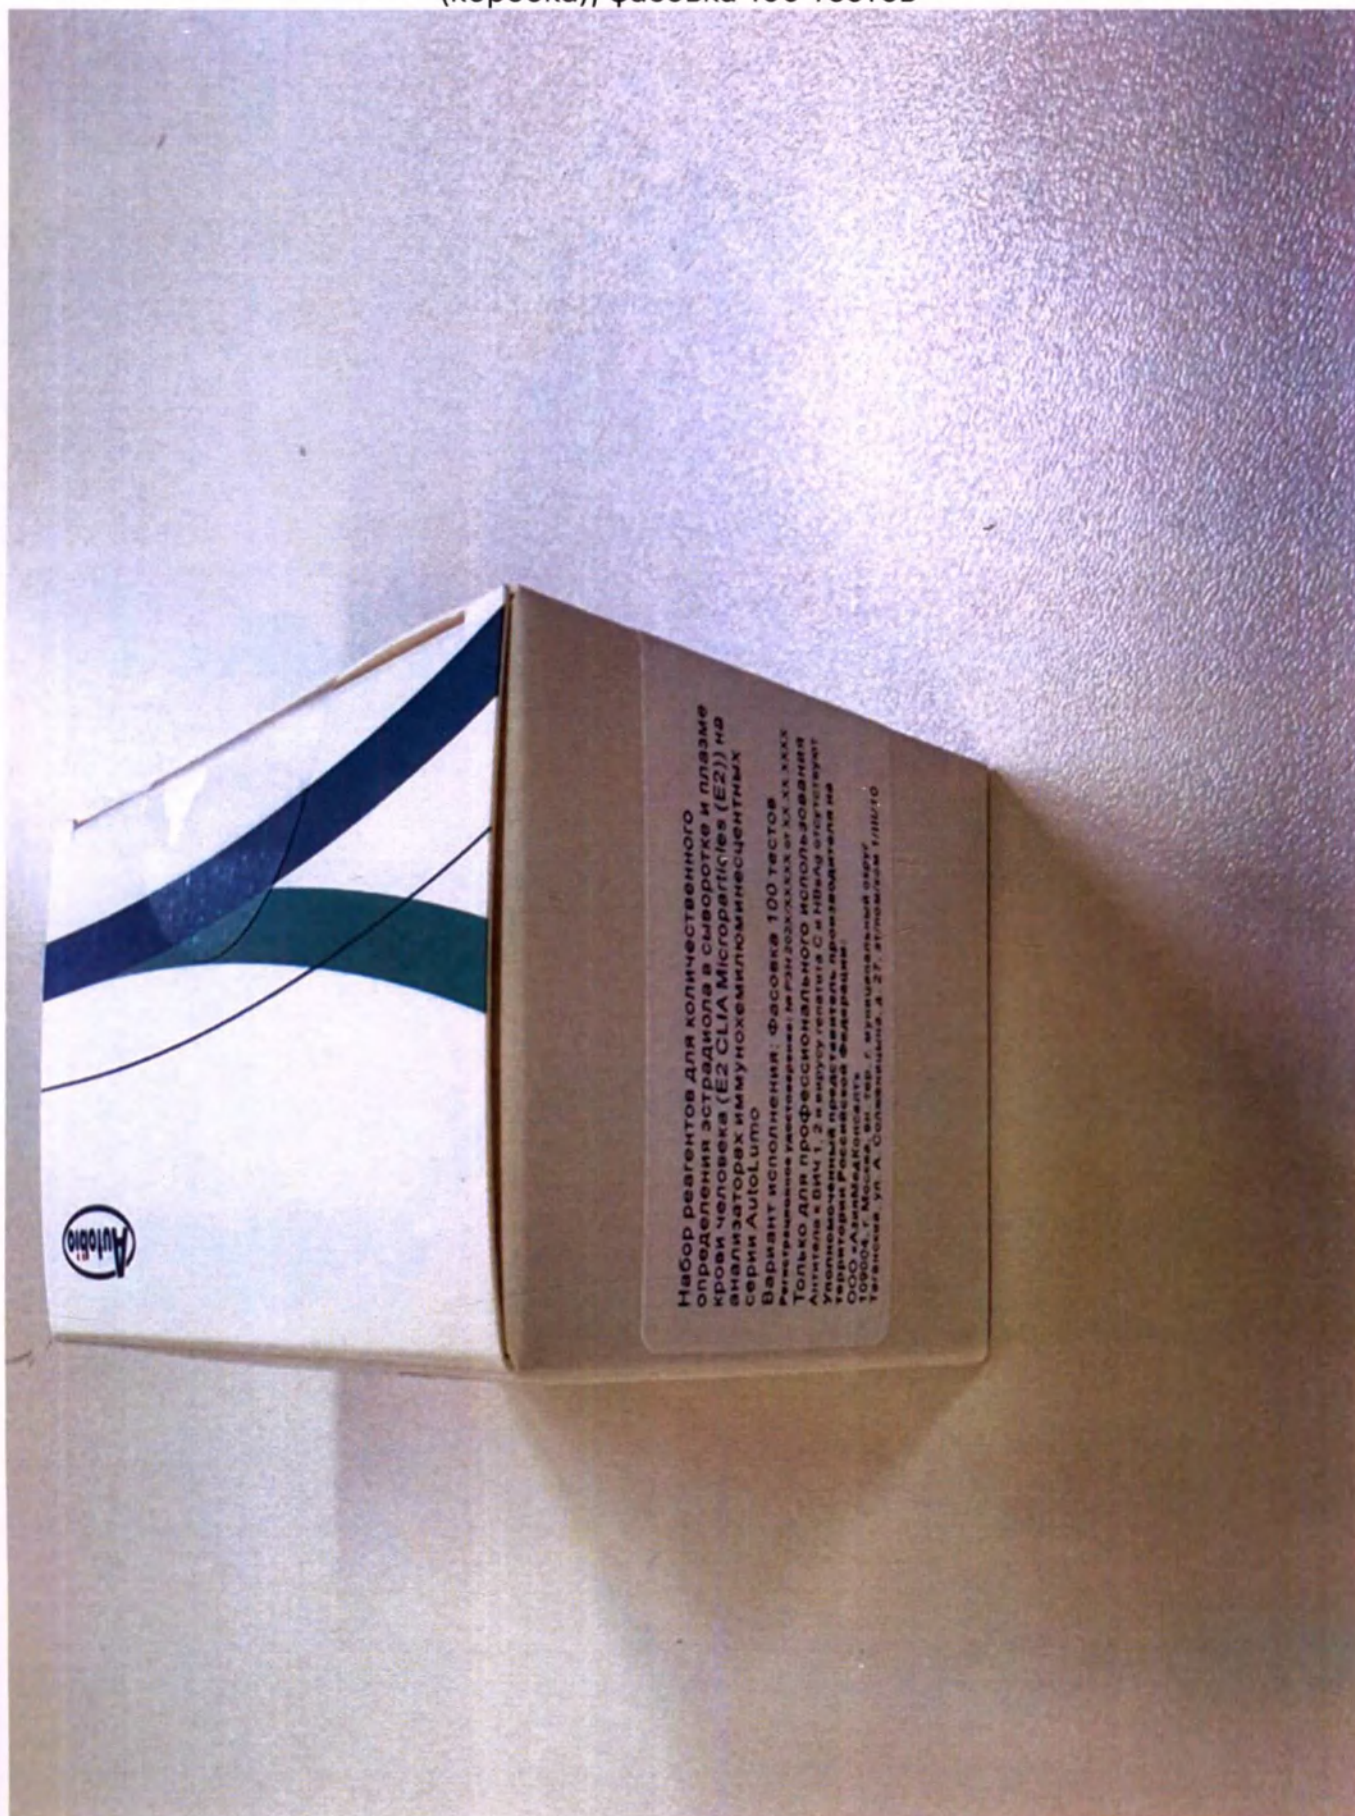





AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No. 87 Linshui Road, Nantong City, Jiangsu
Tech. Development Dept.
China 226001
Tel: +86-513-87118888
Fax: +86-513-87118888
Web: www.autobio.com.cn

Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки
(коробка), фасовка 100 тестов


Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов

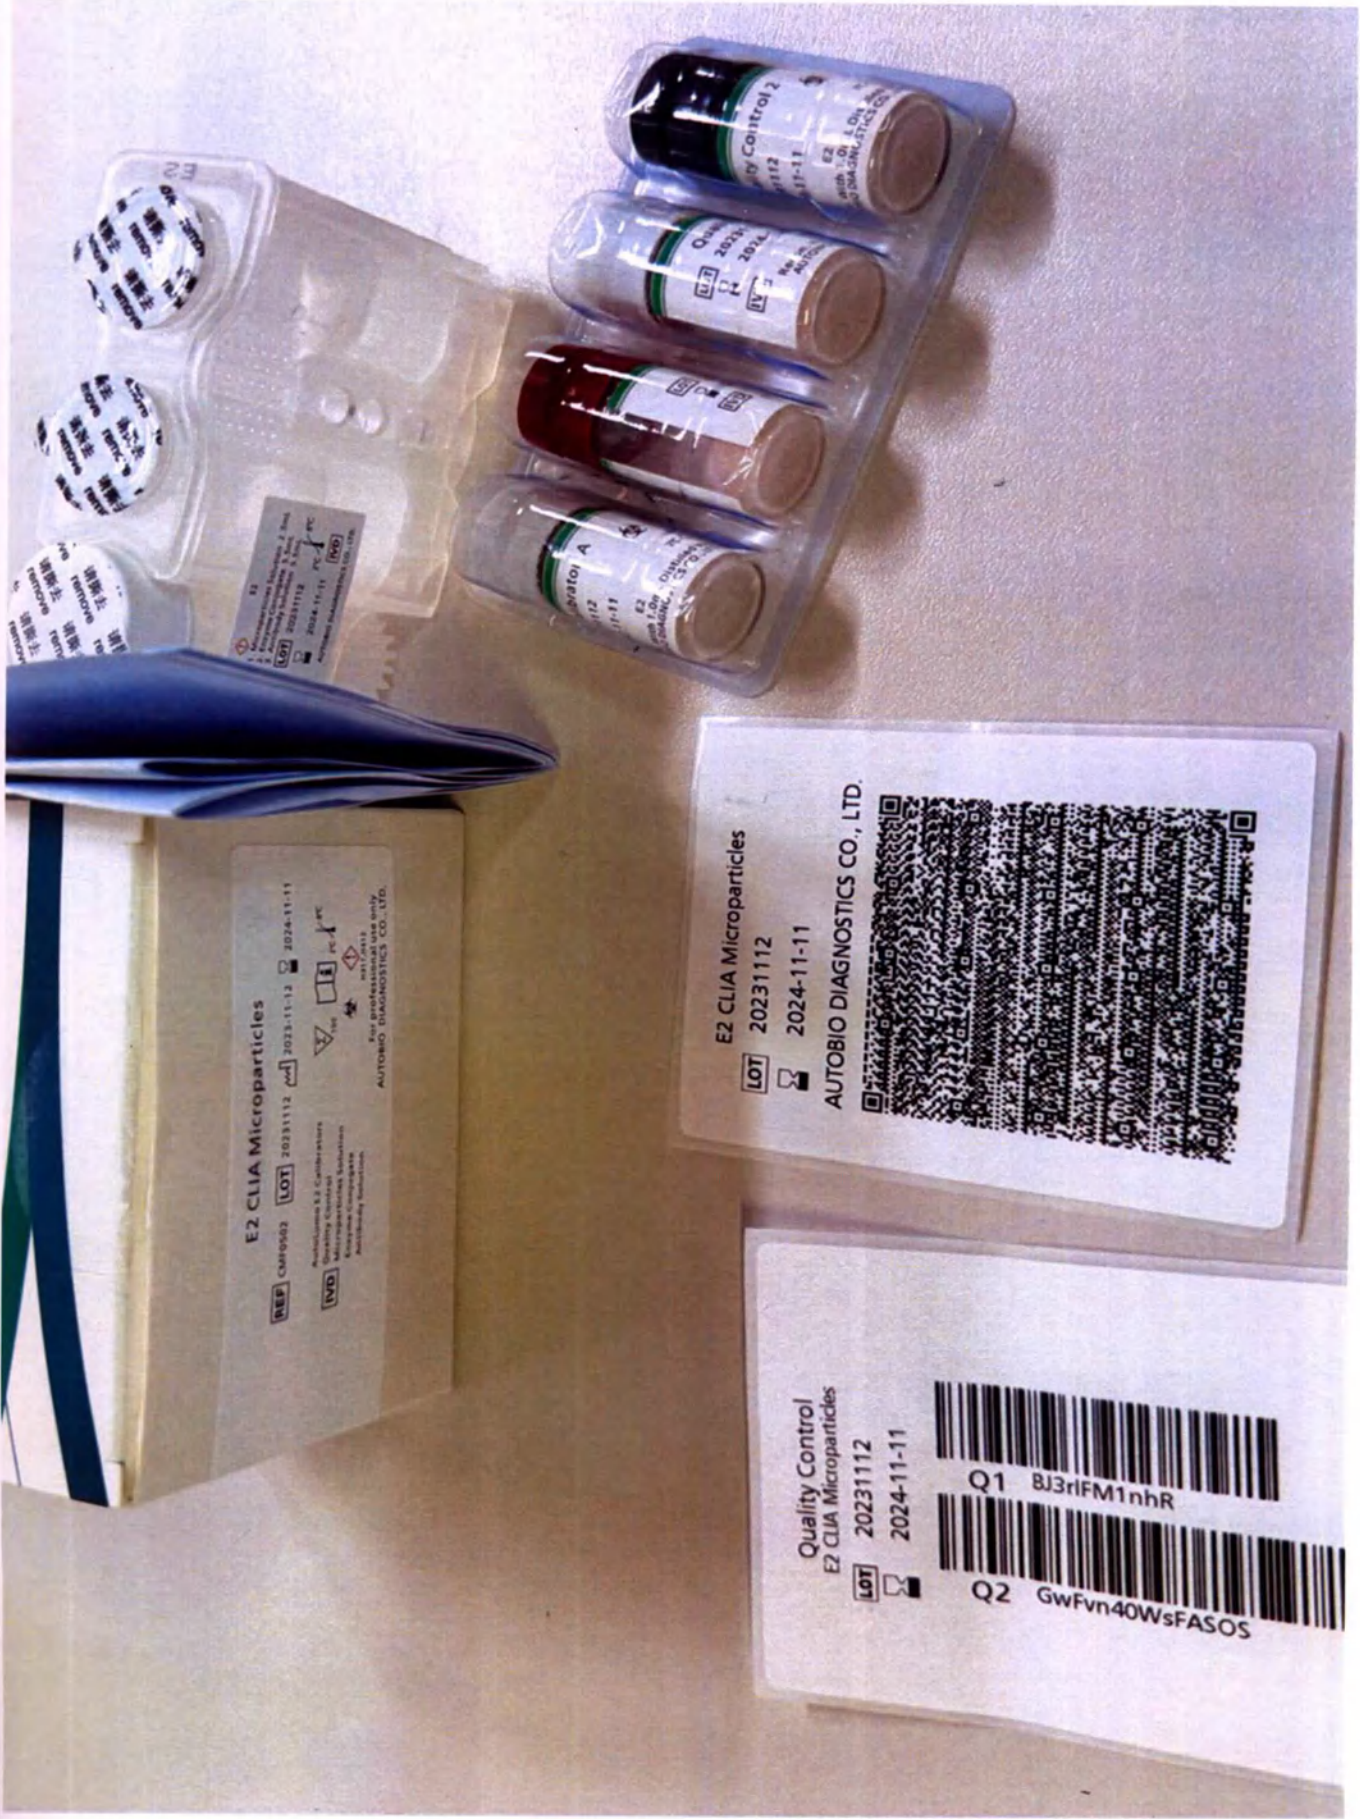

Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*2 тестов

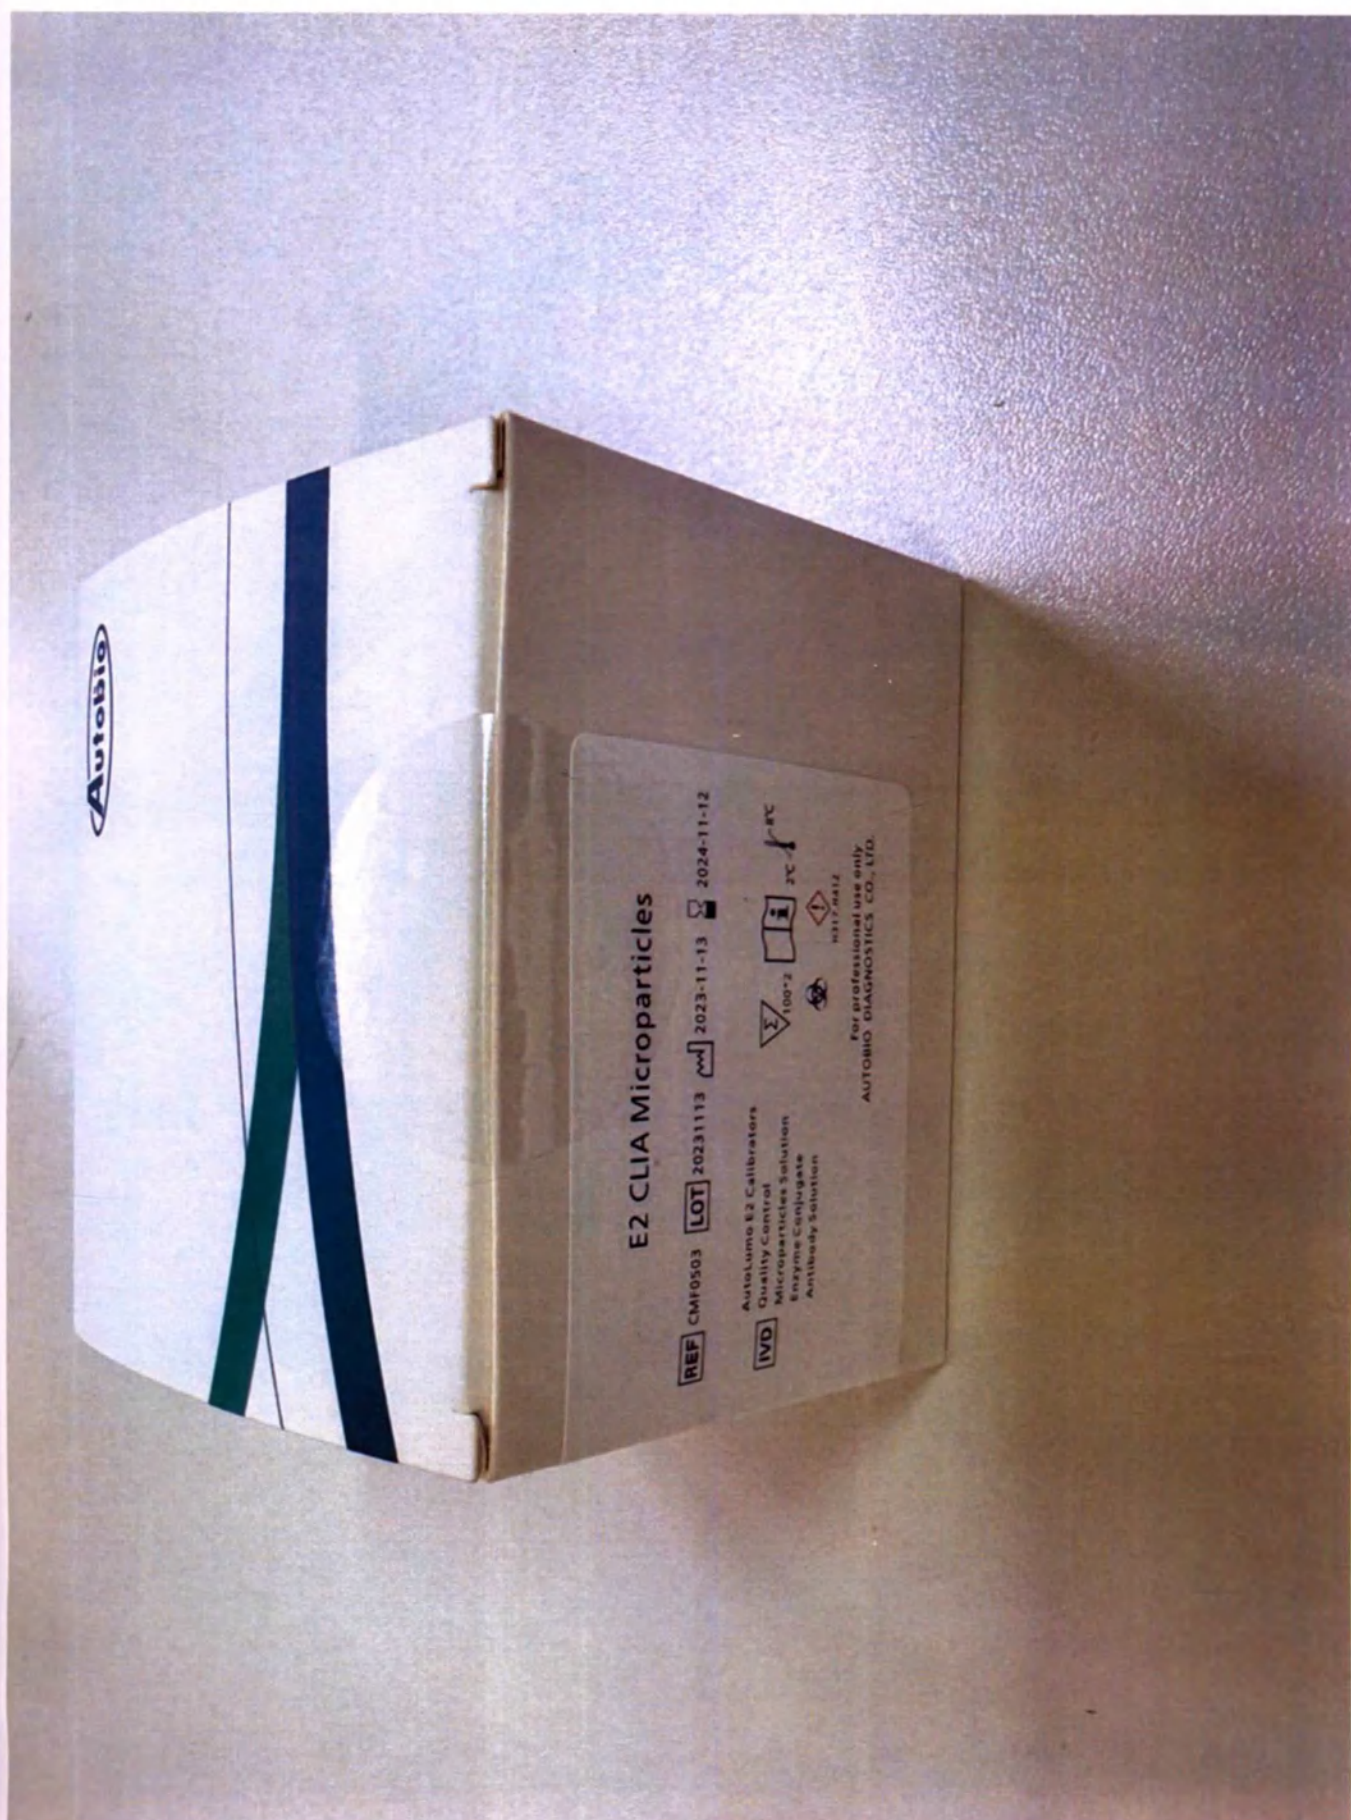

Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*2 тестов

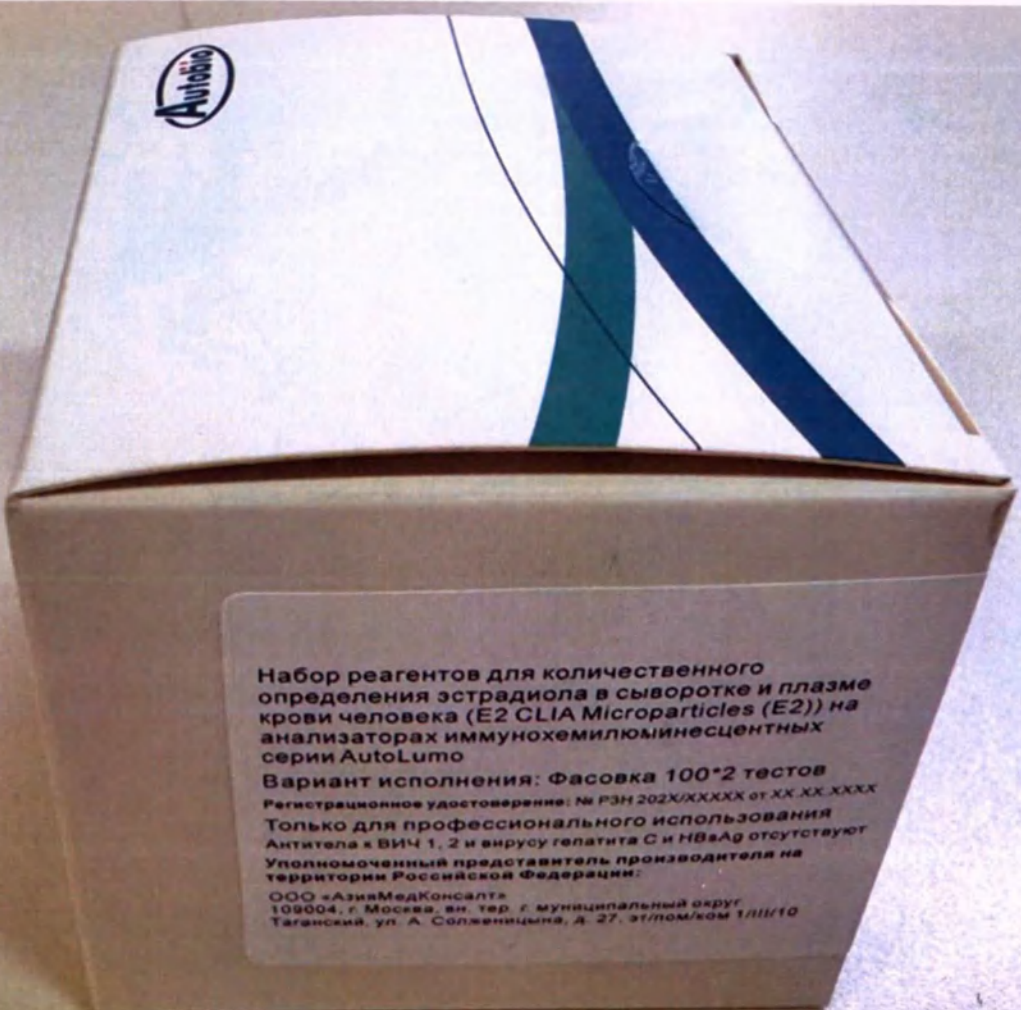

Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека (E2 CLIA Microparticles (E2)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*2 тестов



Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*2 тестов





Фотографическое изображение калибраторов: Калибратор А (Calibrator A) и Калибратор В (Calibrator B)



Фотографическое изображение калибраторов: Калибратор А (Calibrator A) и Калибратор В (Calibrator B)





Фотографическое изображение контролей: Контроль низкого уровня (Quality Control 1) и
Контроль высокого уровня (Quality Control 2)





Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 1



Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 2



Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека (E2 CLIA Microparticles (E2)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № P3H 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

E2 CLIA Microparticles


REF CMF0505

LOT



IVD

AutoLumo E2 Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate
Antibody Solution



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека (E2 CLIA Microparticles (E2)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № P3H 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

E2 CLIA Microparticles


REF CMF0502

LOT



IVD

AutoLumo E2 Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate
Antibody Solution



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека (E2 CLIA Microparticles (E2)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

E2 CLIA Microparticles

REF CMF0503

LOT



IVD


AutoLumo E2 Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate
Antibody Solution



100*2





2°C



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

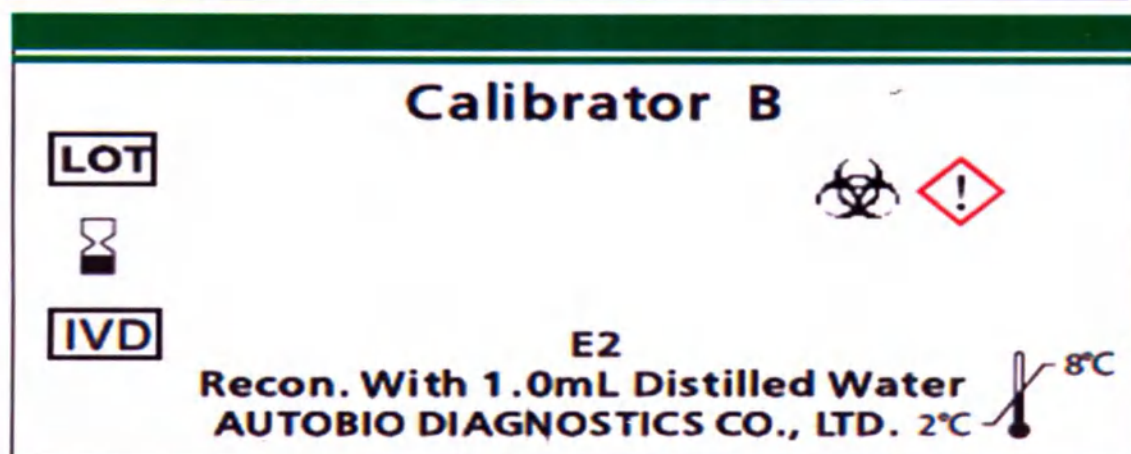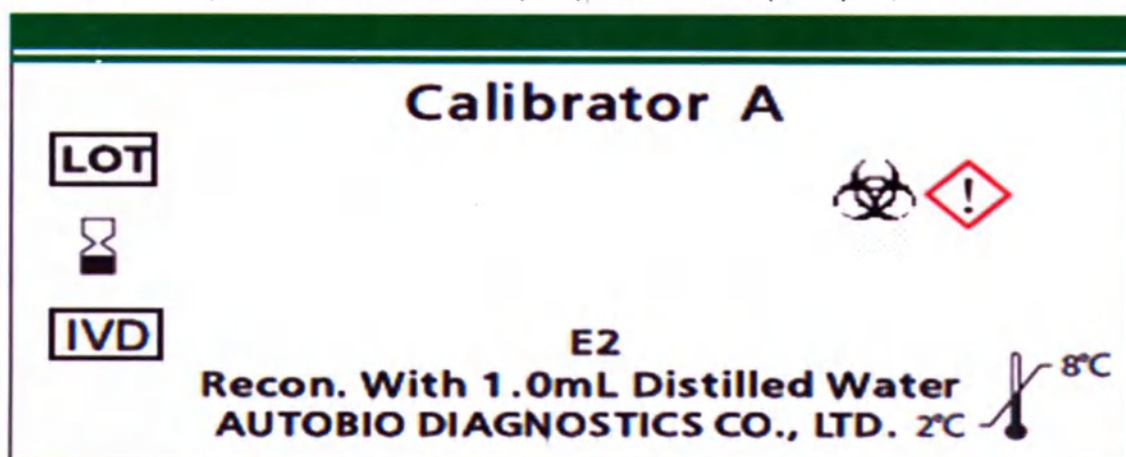

Фотографическое изображение макета маркировки контроля (Quality Control 1 и Quality Control 2)



Маркет маркировки основного реагента для варианта исполнения: фасовка 50*2



E2


1. Microparticles Solution 1.2mL

2. Enzyme Conjugate 3.0mL

3. Antibody Solution 3.0mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Маркет маркировки основного реагента для вариантов исполнения: фасовка 100 и 100*2



E2


1. Microparticles Solution 2.3mL

2. Enzyme Conjugate 5.5mL

3. Antibody Solution 5.5mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
(двадцати пяти) листах

