

143306, Московская область, г. Наро-Фоминск
Ул. Ленина, д.28, помещ.50
Info@expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»
ОГРН: 1197746400620 ИНН/КПП 7726454494/ 503001001



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.

августа 2024 г.

Макет маркировки медицинского изделия Набора реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом латексной агглютинации
«Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024

1. Макет маркировки внешней упаковки

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения

Набор реагентов для определения С-реактивного белка в
сыворотке крови человека методом латексной агглютинации
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024

Комплект ____

____ определений (при использовании 10 мкл реагента)
____ определений (при использовании 20 мкл реагента)

СРБ-реагент - ____ фл. (____ мл), СРБ-позитив контроль - 1 фл.
(____ мл), СРБ-слабопозитив контроль - 1 фл. (____ мл),
СРБ-негатив контроль - 1 фл. (____ мл),

Дилуент - 1 фл. (5 мл), Слайд многократного использования -
____ шт., Палочка для смешивания - ____ шт.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
СРБ-позитив, СРБ-слабопозитив и СРБ-негатив контроли инаktivированы

REF 1050CRPXXXXXX ГГГГ.ММ

Серия XXX ГГГГ.ММ

IVD 2°C 8°C
ПУ №РЗН
2022/18427 от
ДД.ММ.ГГГГ

Наименование предприятия-изготовителя, его адрес и контакты, символы «Медицинское изделие для in vitro диагностики», «Обратитесь к инструкции по применению», «Верх» указаны непосредственно на коробке или на отдельной этикетке:



ООО «Экспресс Мануфактура»



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0



143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



2. Макет маркировки компонентов медицинского изделия

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»

СРБ-негатив контроль

Комп. _____

LOT

XXX



ГГГГ.ММ

инактивирован

8°C

_____ мл 2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»

СРБ-слабоположительный контроль

Комп. _____

LOT

XXX



ГГГГ.ММ

инактивирован

8°C

_____ мл 2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»

СРБ-положительный контроль

Комп. _____

LOT

XXX



ГГГГ.ММ

инактивирован

8°C

_____ мл 2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»

СРБ-реагент

Комп. _____

LOT

XXX



ГГГГ.ММ

8°C

_____ мл 2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»

Дилуэнт

LOT

XXX



ГГГГ.ММ

8°C

5 мл 2°C



«Экспресс-М-СРБ-латекс»
Слайд многократного использования
_____ шт.

LOT XXX

«Экспресс-М-СРБ-латекс»
Палочка для смешивания



LOT XXX


3. Макет маркировки транспортной упаковки

ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский,
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50

Набор реагентов для определения С-реактивного
белка в сыворотке крови человека методом латексной
агглютинации «Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024

Серия XXX

ГГГГ.ММ.
ГГГГ.ММ.



XX шт.

2°C

Масса нетто: XXXX г

Масса брутто: XXXX г

Масса нетто потребительской упаковки: XXXX г



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества


С.А. Цыганков

Е.Д. Головкина

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

3 лист а

Генеральный директор
ООО "Экспресс Мануфактура"


Киреев И.В.



📍 143306, Московская область, г Наро-Фоминск, г.о.
Наро-Фоминский, ул Ленина, д.28, помещ.50
☎ +7 (495) 190-00-05
✉ Info@expressm-test.ru
🌐 www.expressm-test.ru


Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Киреев И.В.
« 9 » _____ сентября _____ 2024 г.

Фотографические изображения общего вида


**Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека
методом латексной агглютинации «Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024**

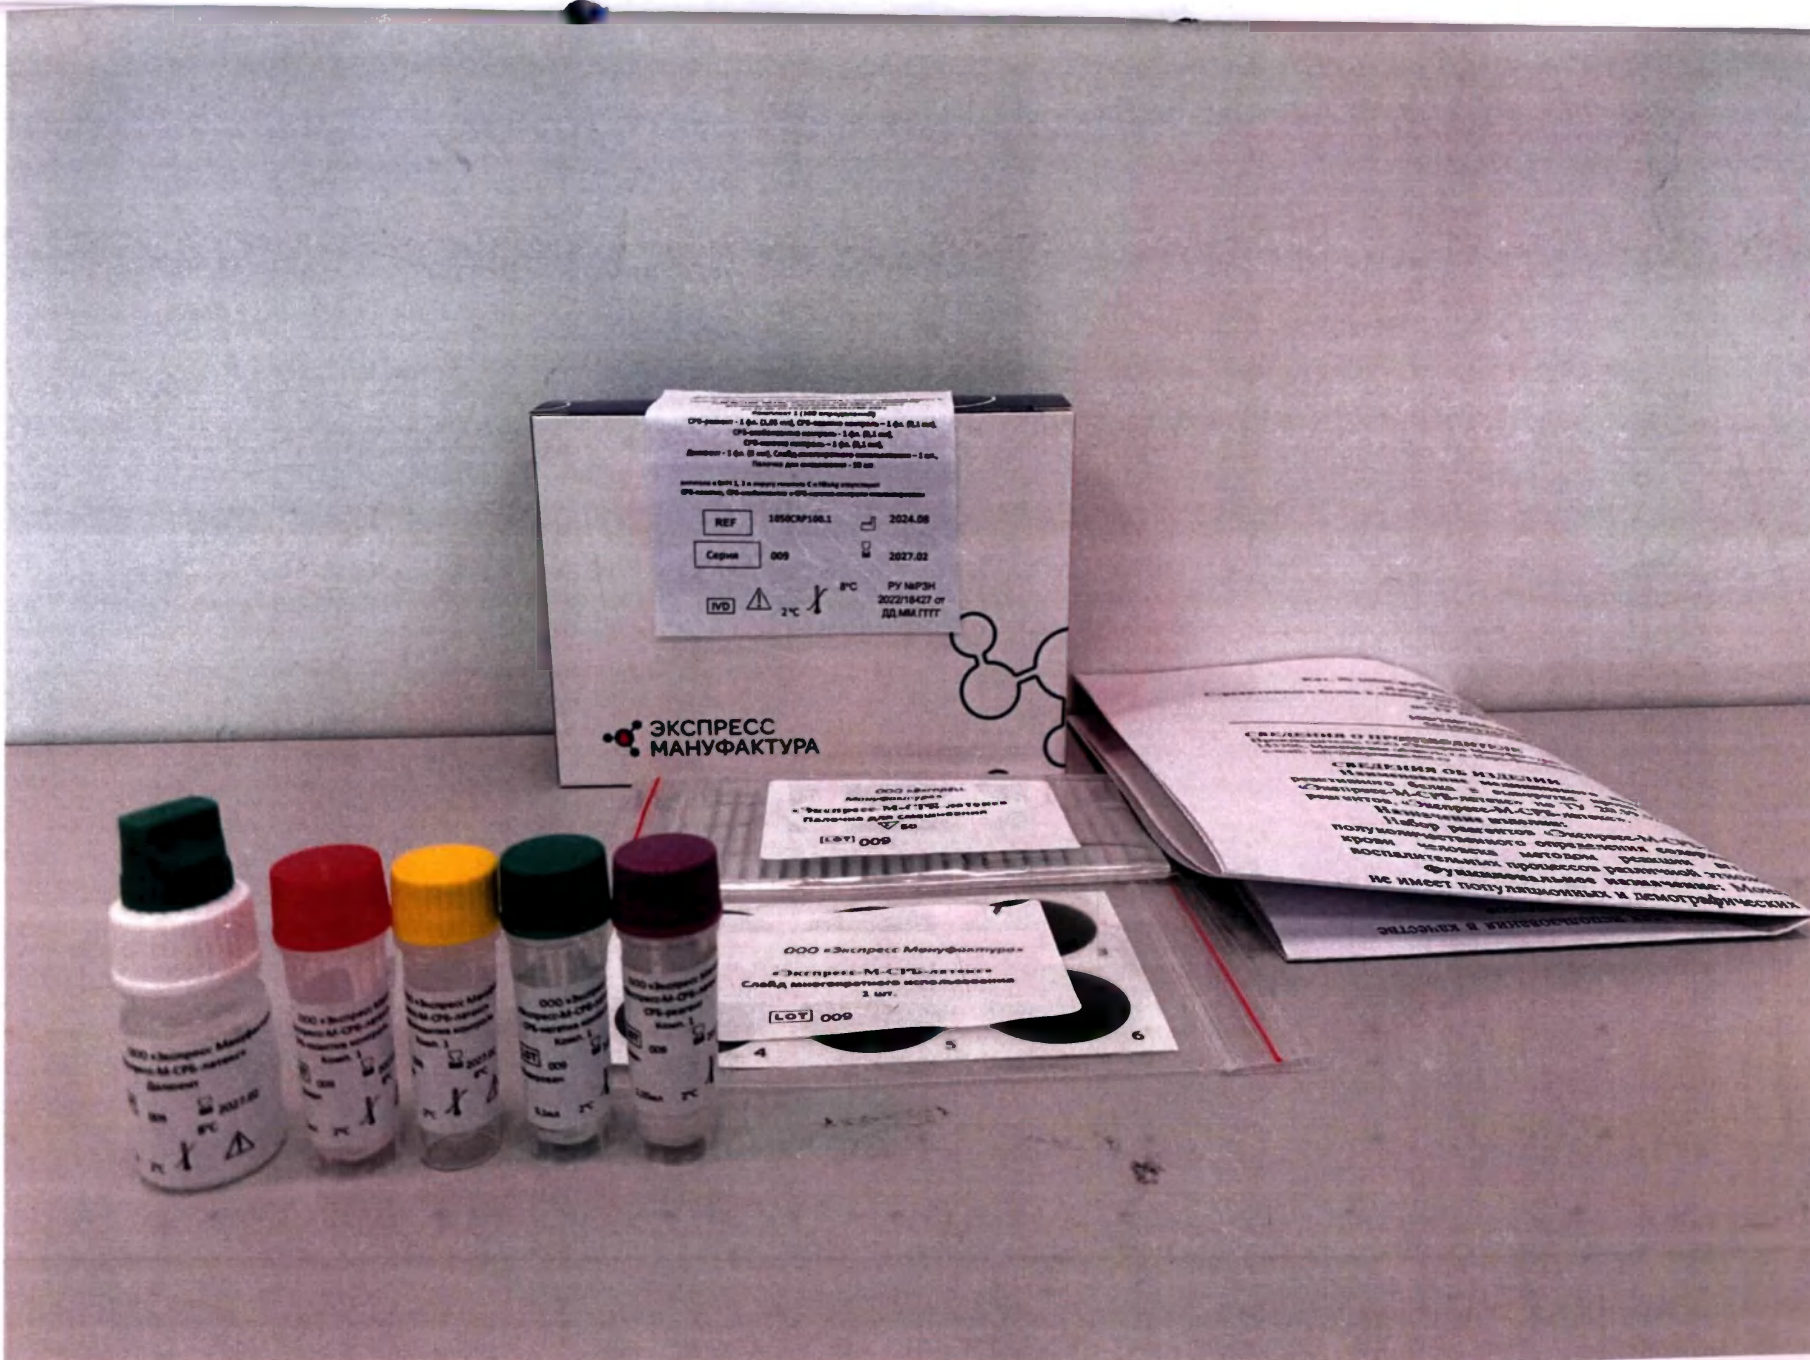


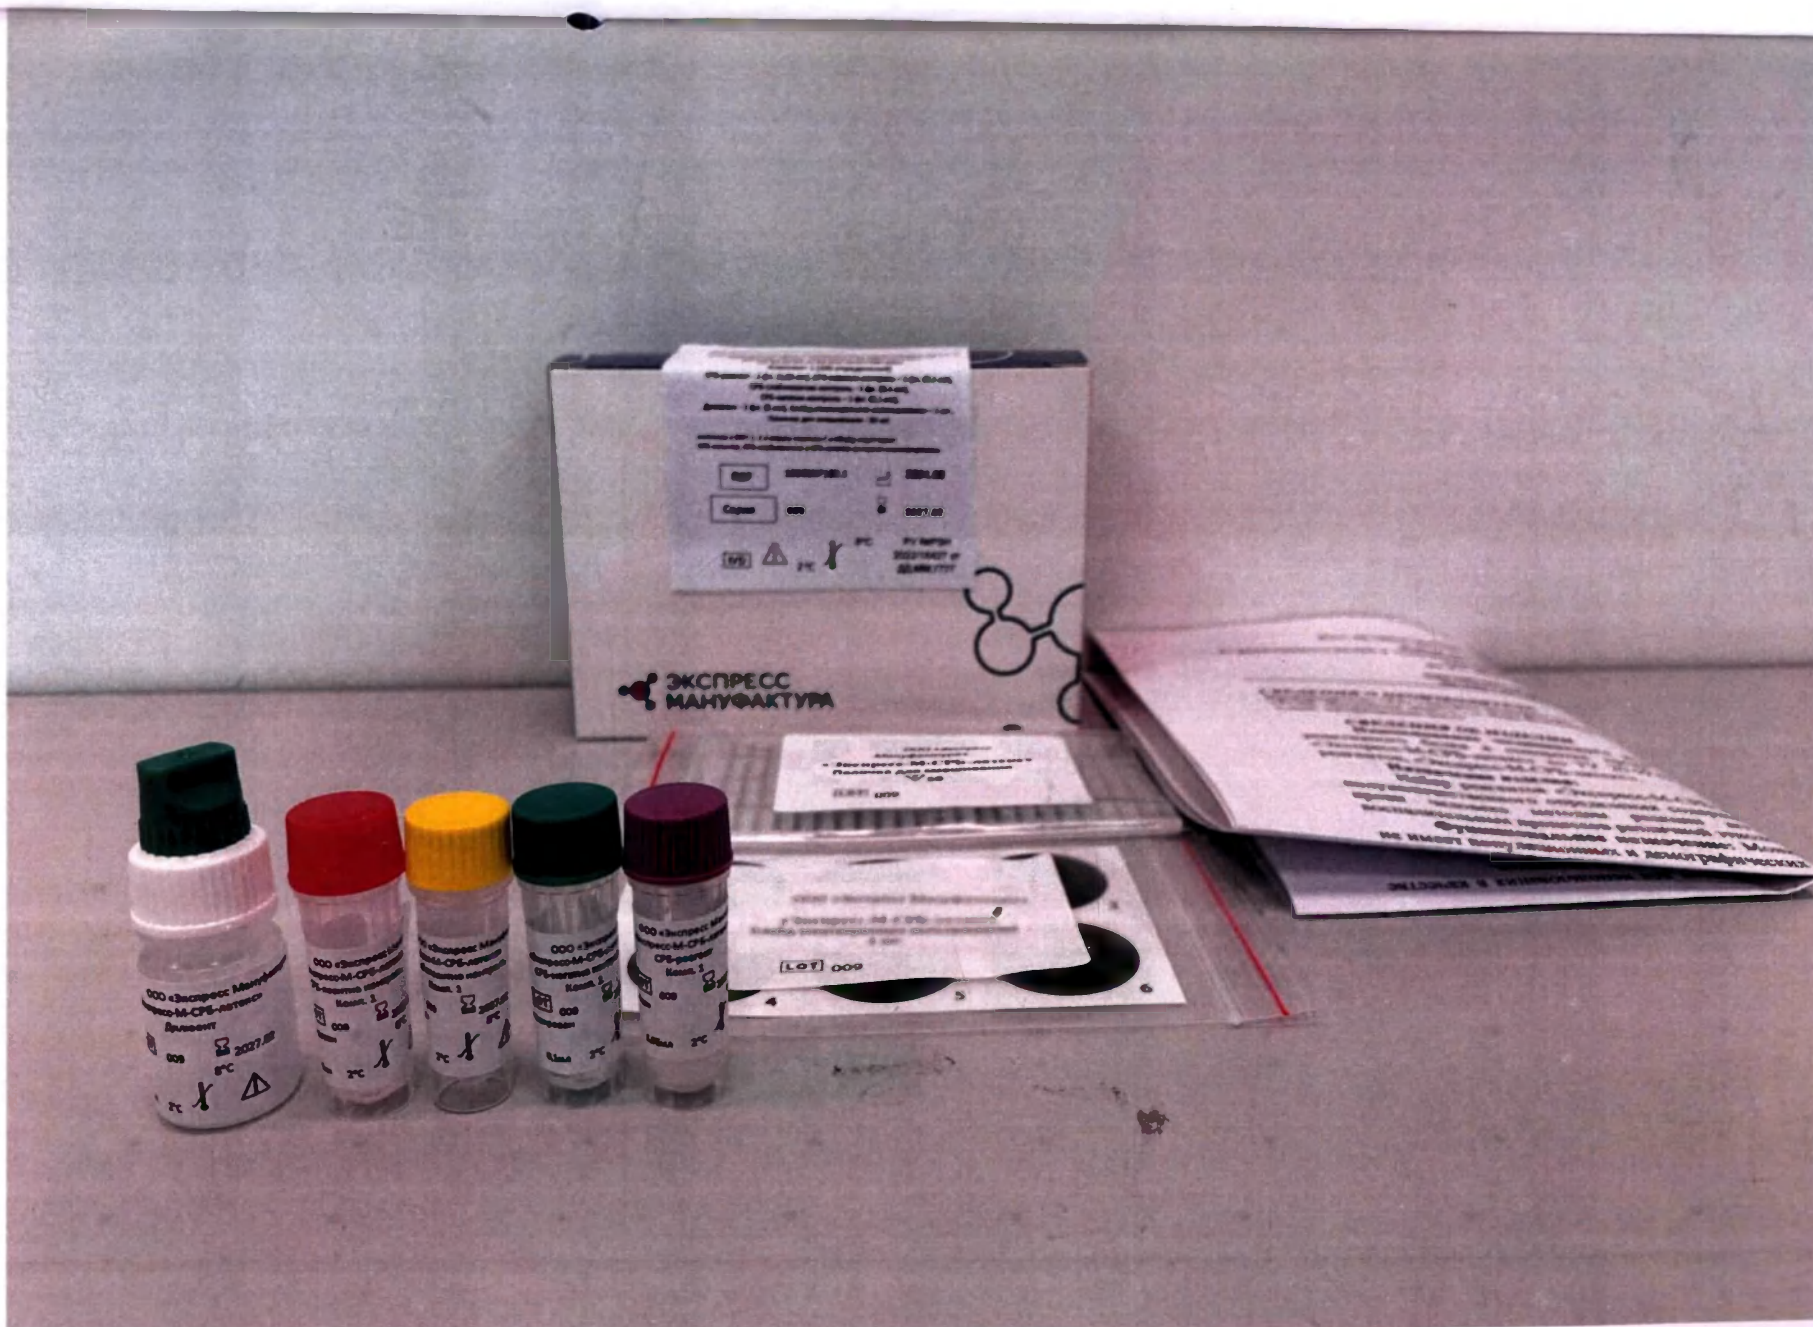

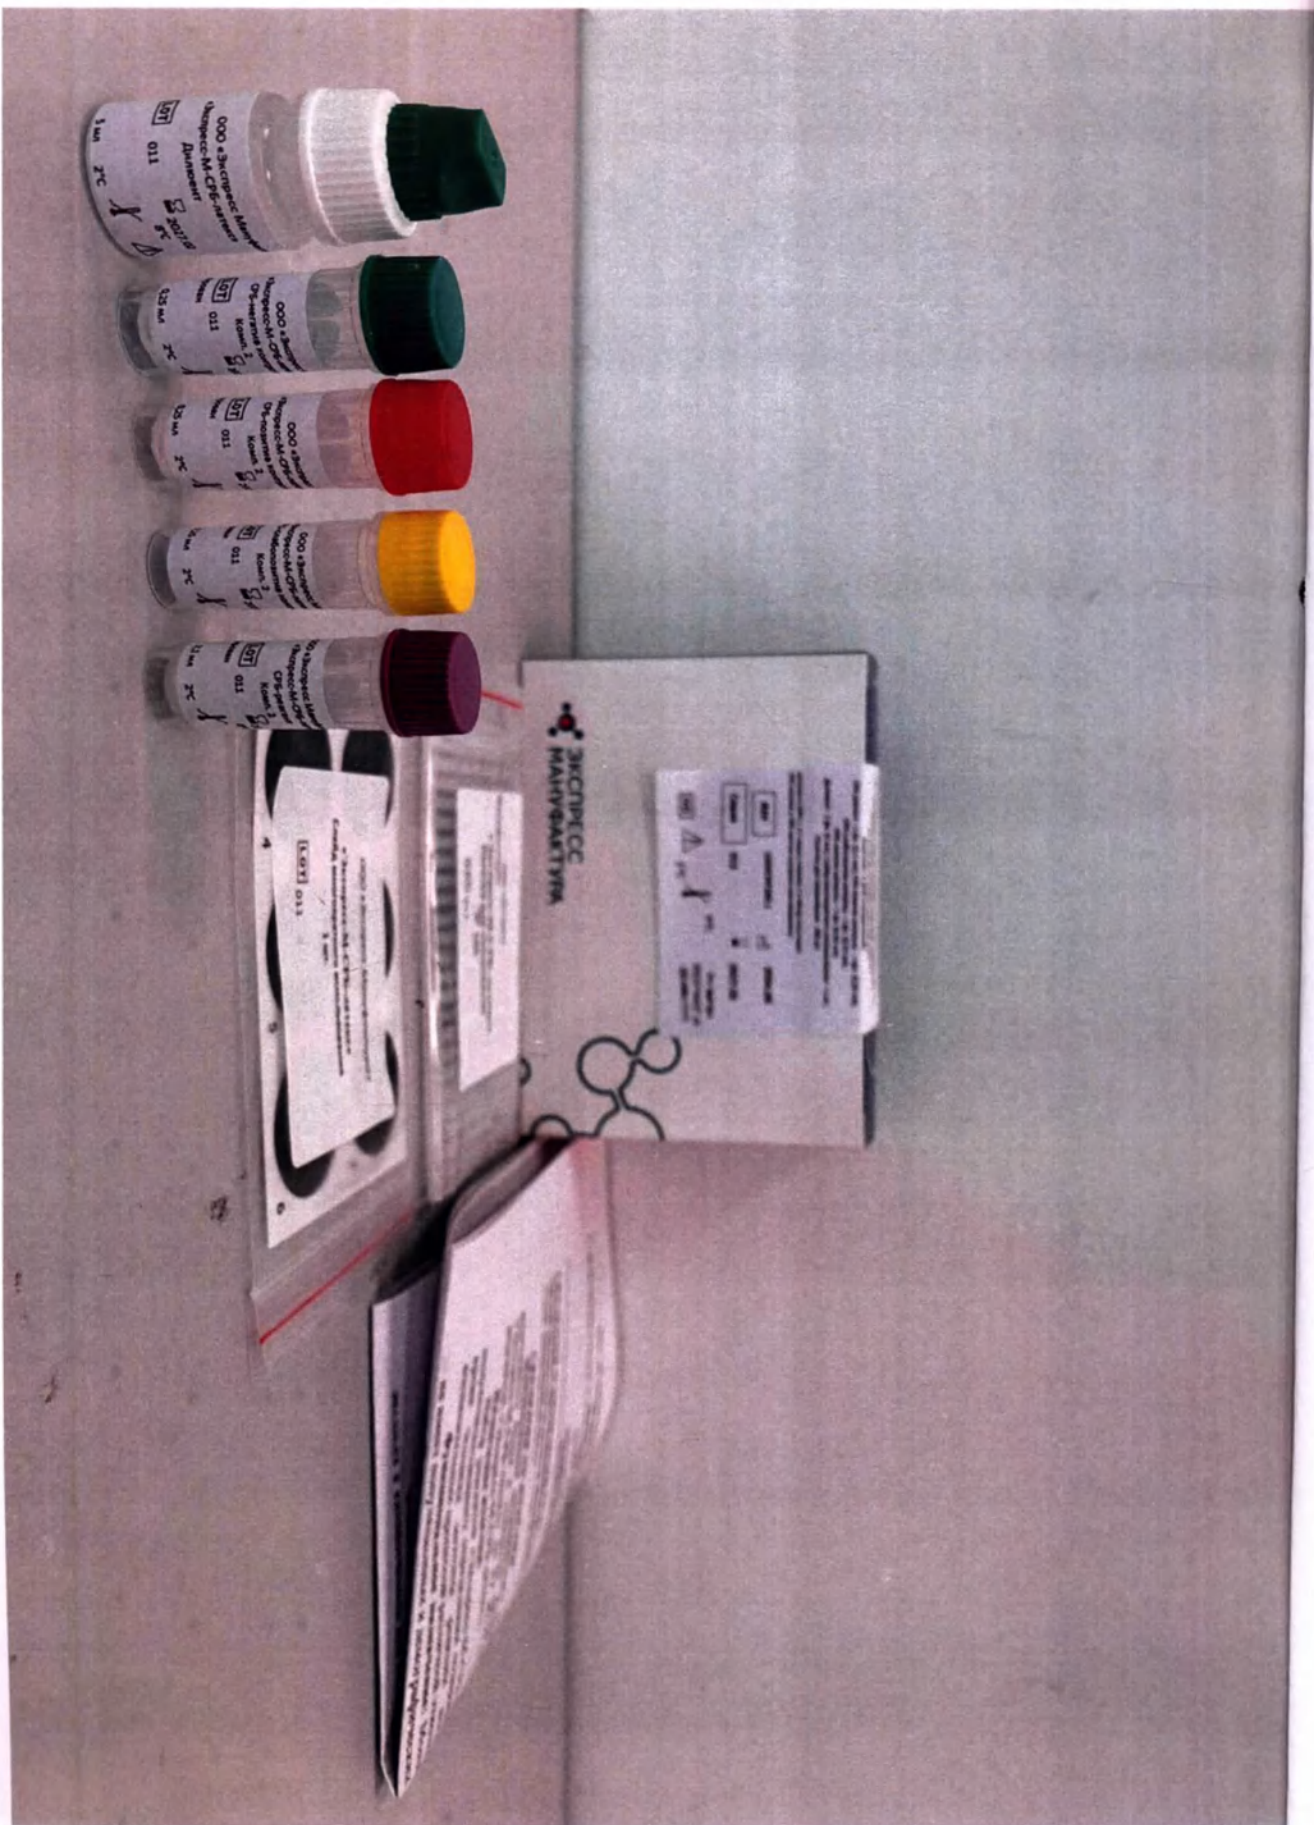

5

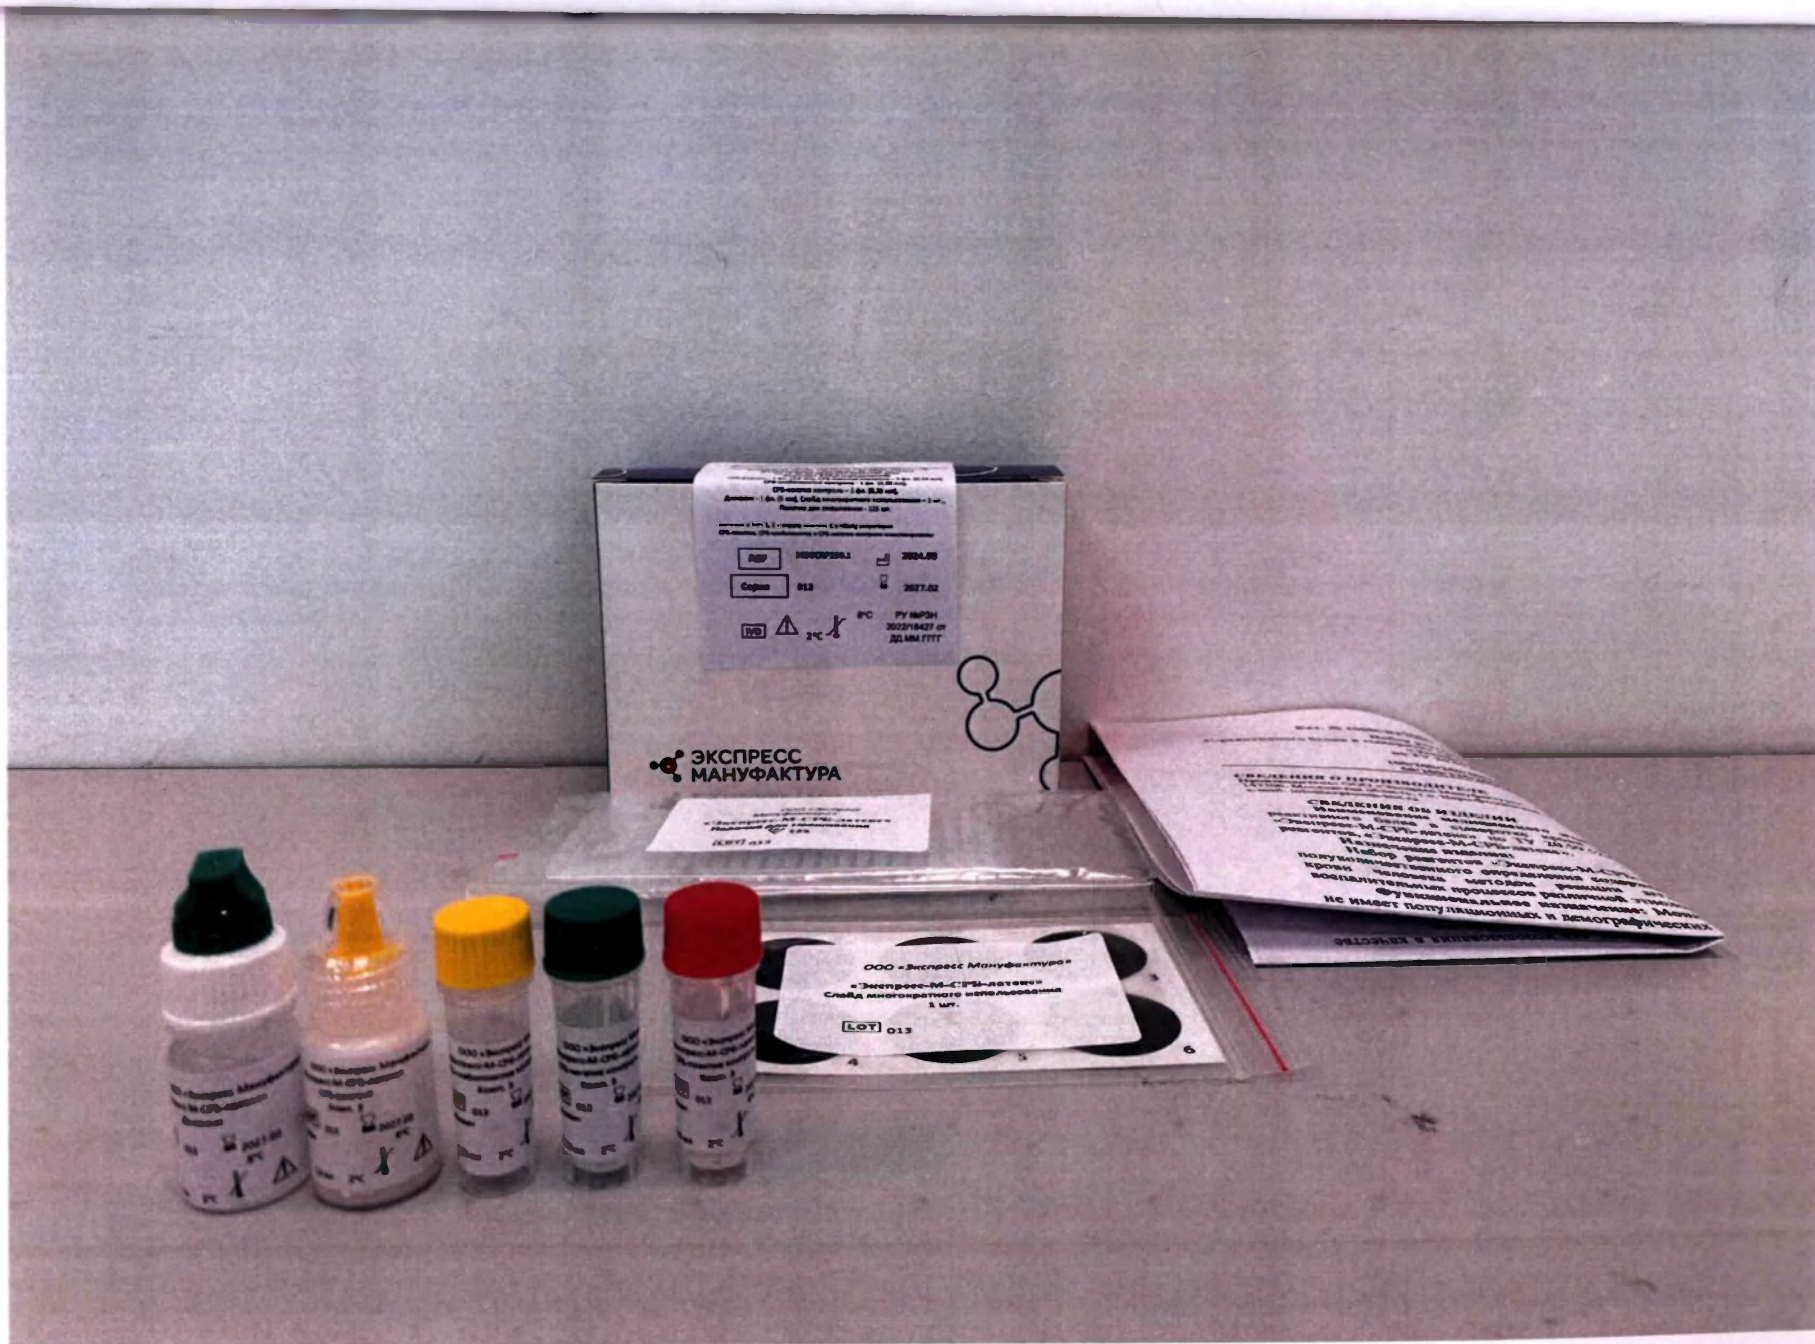

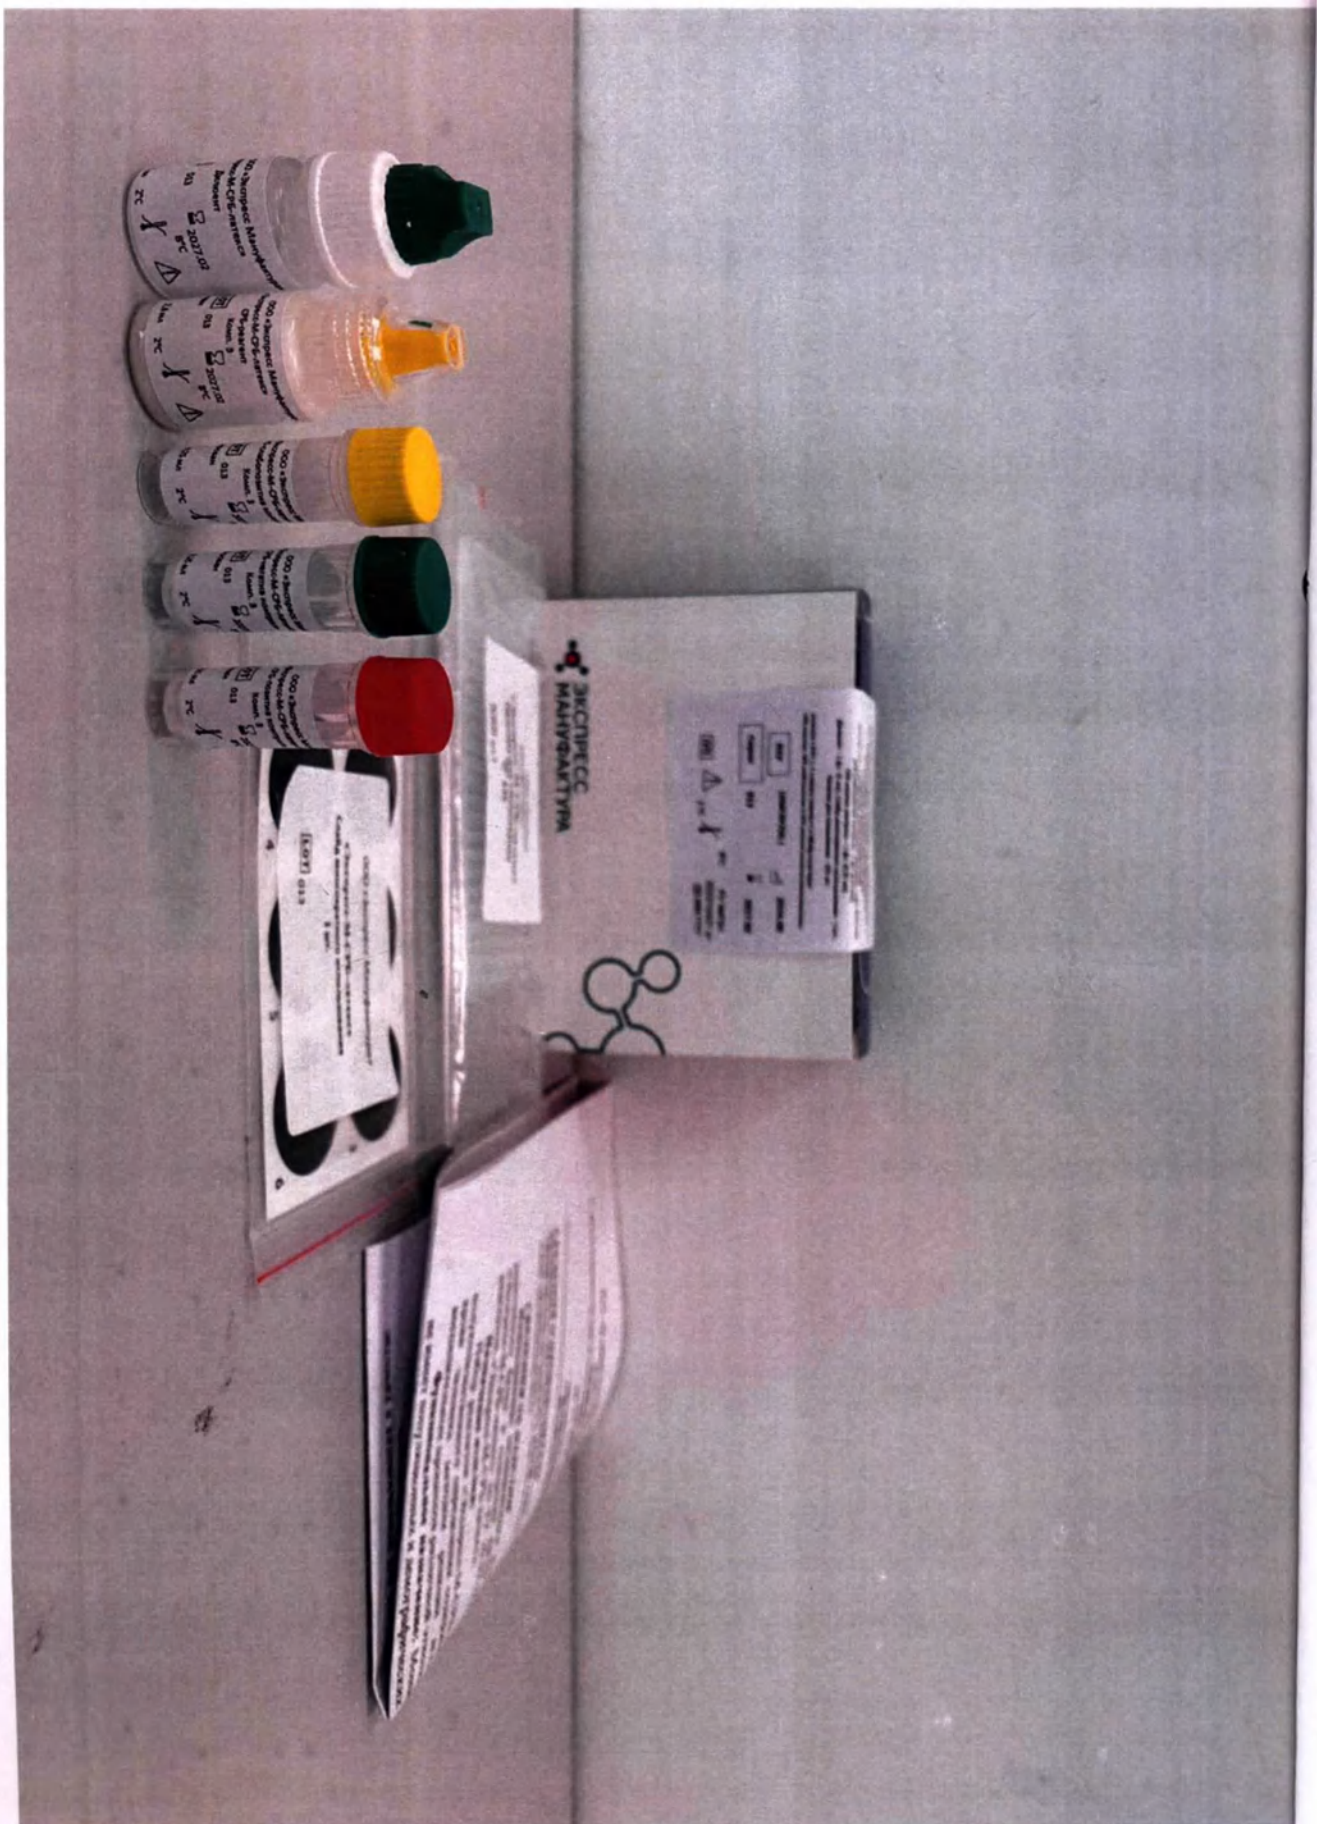




[illegible]

LOT 013

LOT 013

10

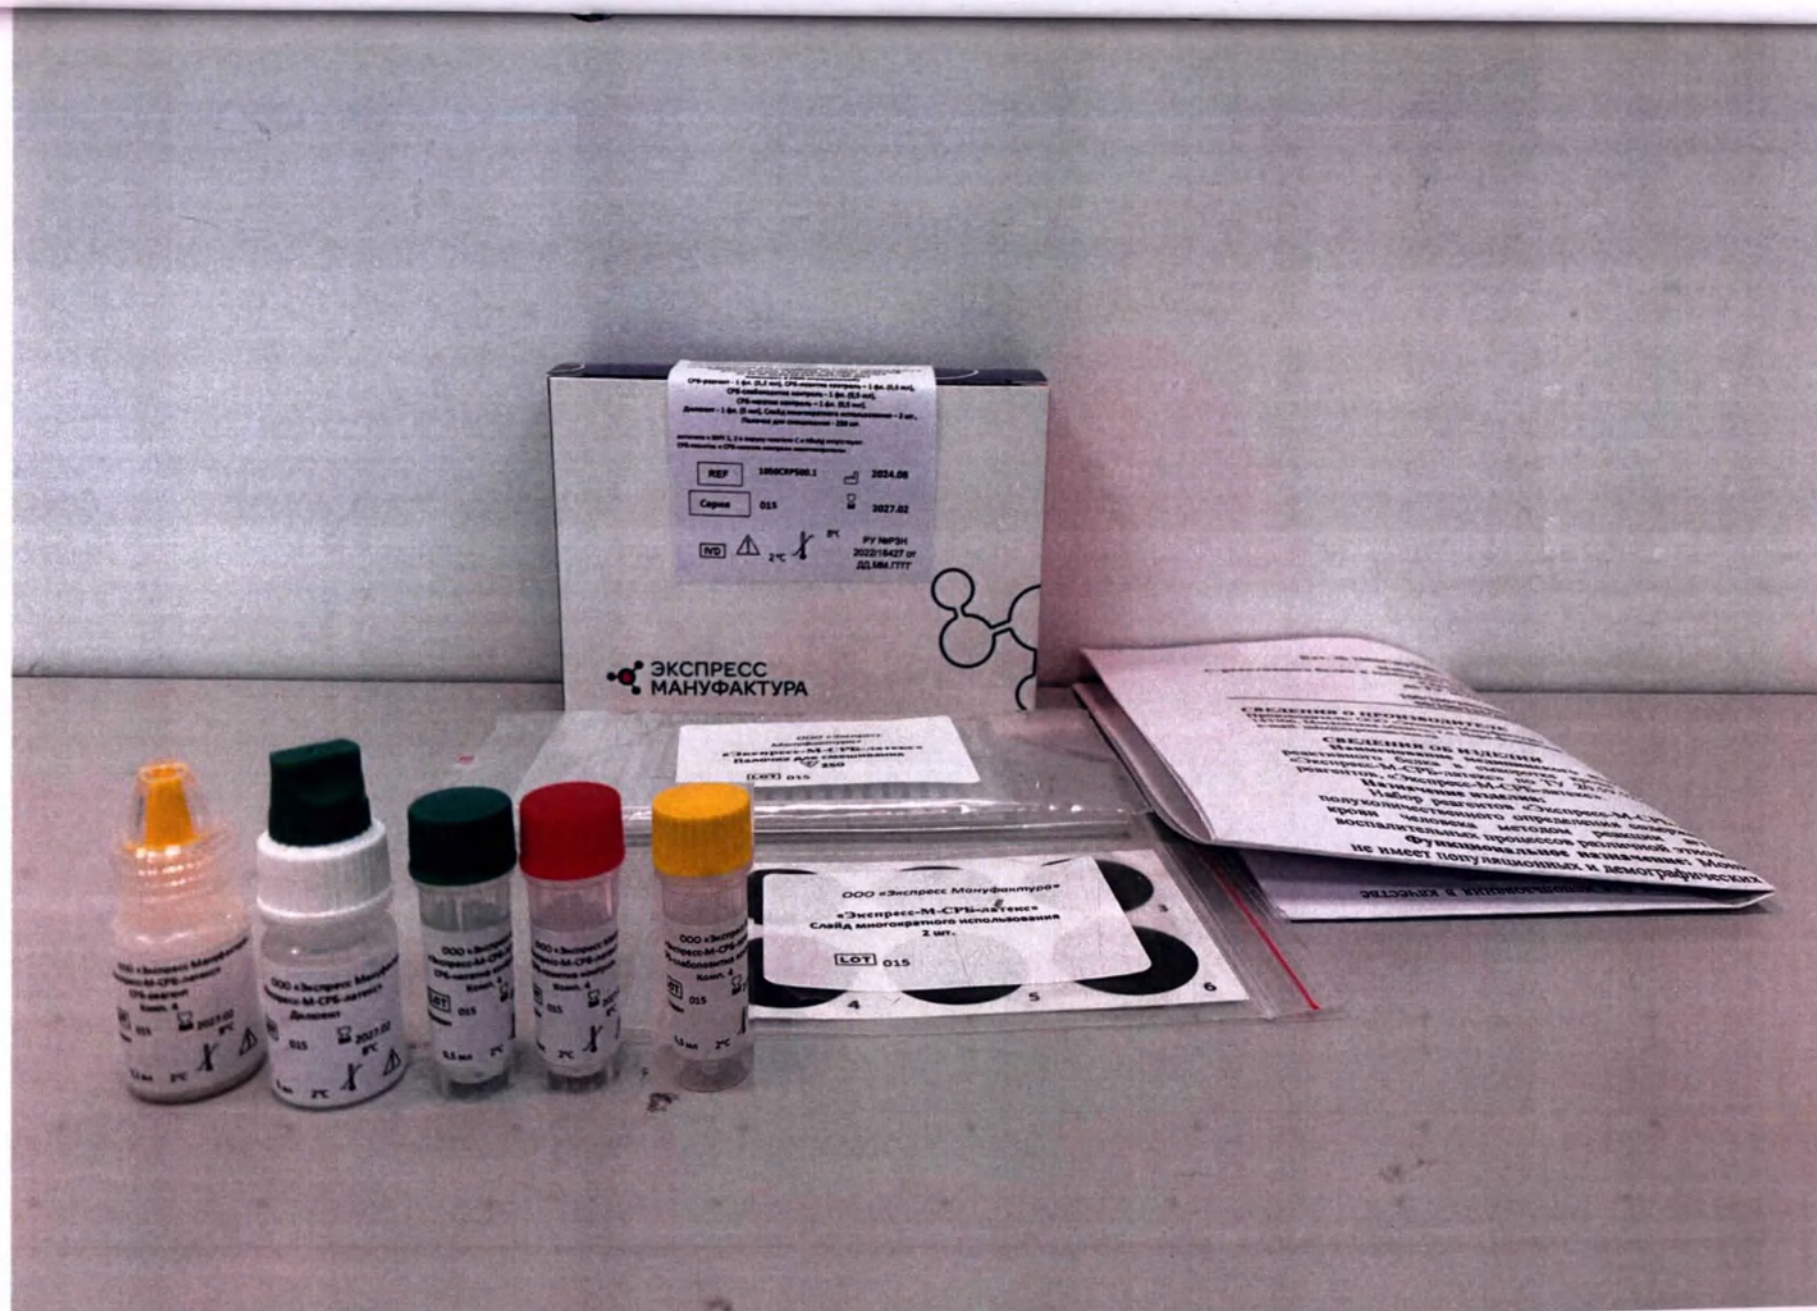


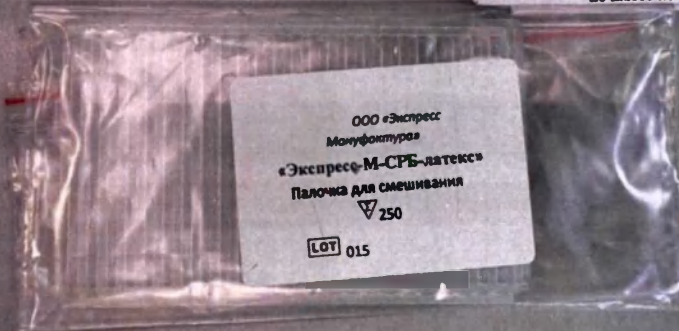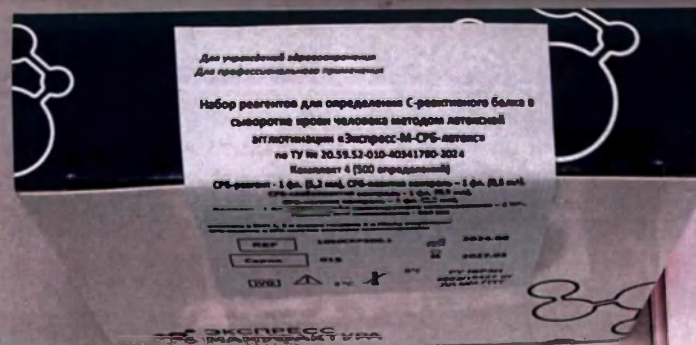


Кат. № 1050CRP **IVD** Таблетки
Набор реагентов для определения
С-реактивного белка в сыворотке крови человека
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024
100/200/250/400/500/550/600/700/800/900/1000
50/100/125/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г.п. Наро-Фоминское
e-mail: info@ekspress-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом латексной агглютинации «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024.
Назначение изделия: Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-латекс» предназначен для полуквантитативного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации. Применяется для диагностики воспалительных процессов различной этиологии.
Функциональное назначение: Мониторинг воспалительных процессов. Не имеет популяционных и демографических различий.

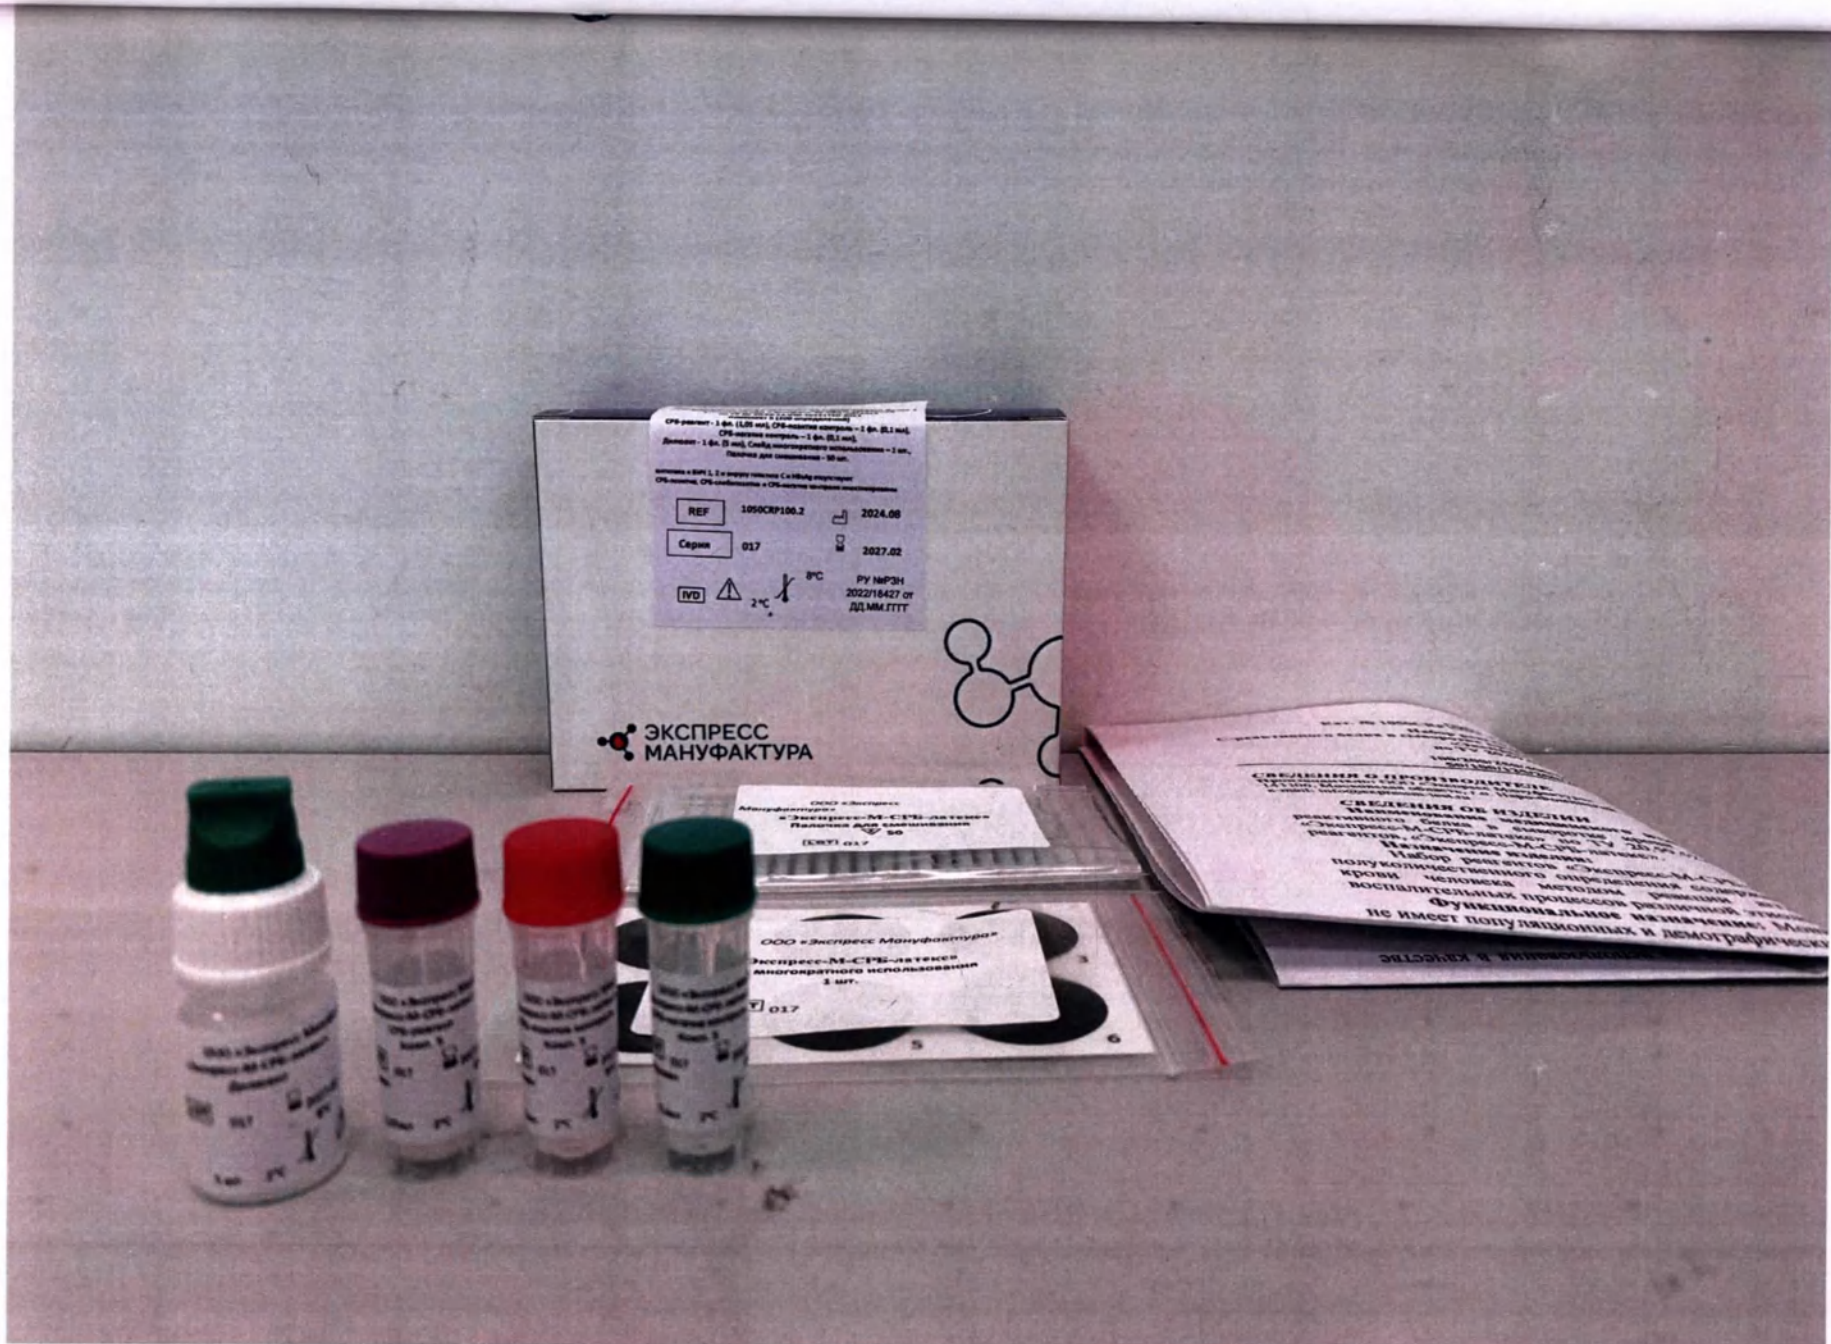

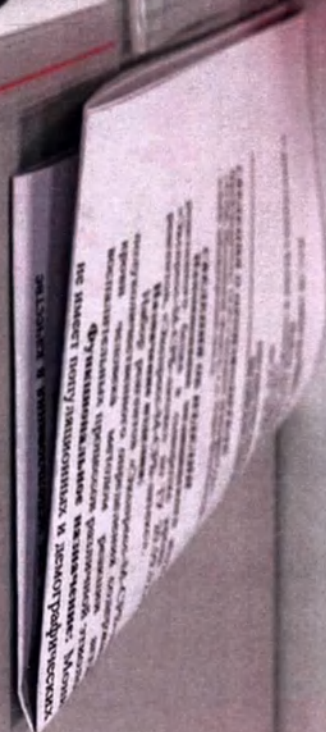

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения

Набор реагентов для определения С-реактивного белка в
сыворотке крови человека методом латексной
агглютинации «Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024
Комплект 5 (100 определений)

СРБ-реагент - 1 фла. (1,05 мл), СРБ-показатель контроля - 1 фла. (0,1 мл),
СРБ-показатель калибратора - 1 фла. (0,1 мл),
Диспергент - 2 фла. (20 мл), Слайды многоразового использования - 1 шт.

Упаковка: 5 фла. в 1 шт. картонной коробке, 1 шт. картонной коробке в 1 шт. картонной коробке.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Кат. № 1050CRP [VD] Тел.

Набор реагентов для
С-реактивного белка в сыворотке крови че
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ 20.59.52-010

100/200/250/400/500/
50/100/125/200/250/

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Н
e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия:
реактивного белка в сыворотке крови че
«Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-0
реагентов, «Экспресс-М-СРБ-латекс».

Назначение изделия:

Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-ла
полуколичественного определения содержа
крови человека методом реакции аггл
воспалительных процессов различной этиолог

Функциональное назначение: Мониторинг
не имеет популяционных и демографических

ООО «Экспресс
Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»
Палочка для смешивания

50




LOT 017

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»
Слайд многократного использования
1 шт.

LOT 017



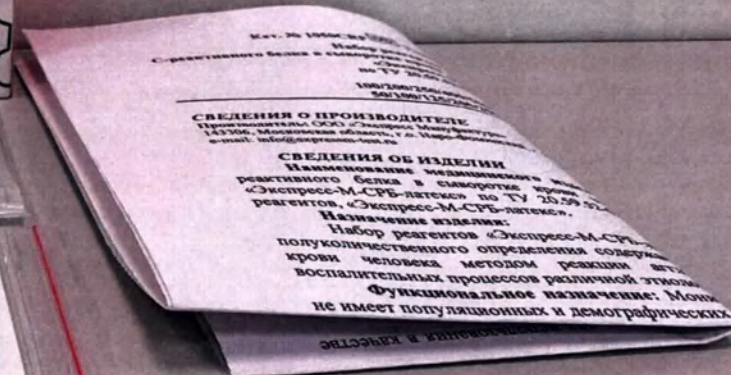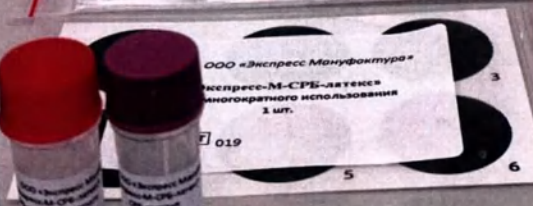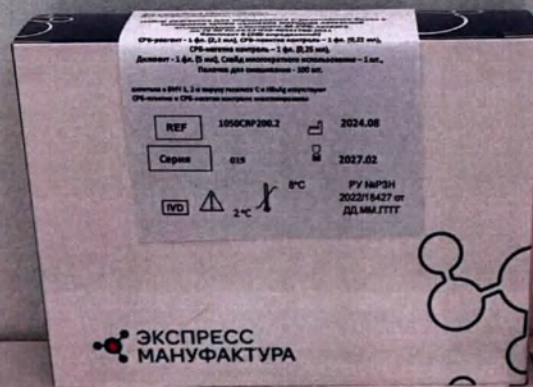



*Chloro-*S. longipennis**
Adomphalopora n.
n. *B. intermedia*-N-G-178-10 to be
Machona from Chatham Island
V 325
[LOT] 021


ООО «Экспресс Мотивоплюс»
«Экспресс-М-СРБ-анализ»
Система мониторинга и контроля
1 шт.

ЭКСПРЕСС
МАНУФАКТУРА

[illegible]



М. в. 1917. Изд. 1000 экз. 1918.

С. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915.



CHINA'S "REPUBLICAN" DEMOCRACY
OF "FREE SPEECH" AND "FREE PRESS"
Canada's anti-communism before the war
S. 1001

[illegible]

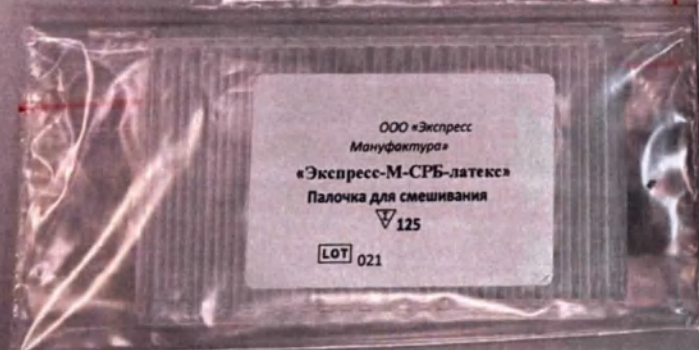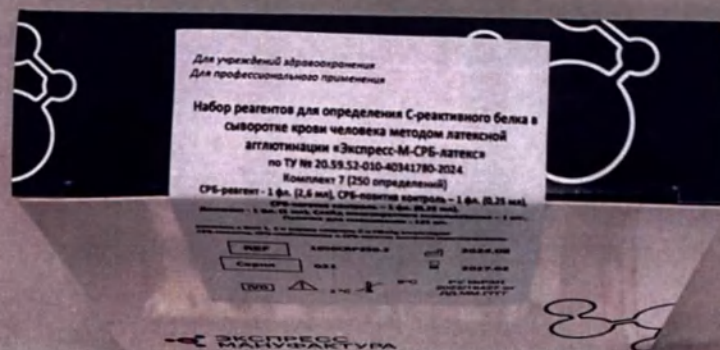


Кат. № 1050CRP IVD Только
 Набор реагентов для определения
 С-реактивного белка в сыворотке крови человека
 «Экспресс-М-СРБ-латекс»
 по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024
 100/200/250/400/500/500
 50/100/125/200/250/500

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
 143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г.п. Наро-Фоминский
 e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия:
 реактивного белка в сыворотке крови человека
 «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024
 реагентов, «Экспресс-М-СРБ-латекс».

Назначение изделия:
 Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-латекс» для
 полуколичественного определения содержания
 крови человека методом реакции агглютинации
 воспалительных процессов различной этиологии.
Функциональное назначение: Мониторинг
 не имеет популяционных и демографических

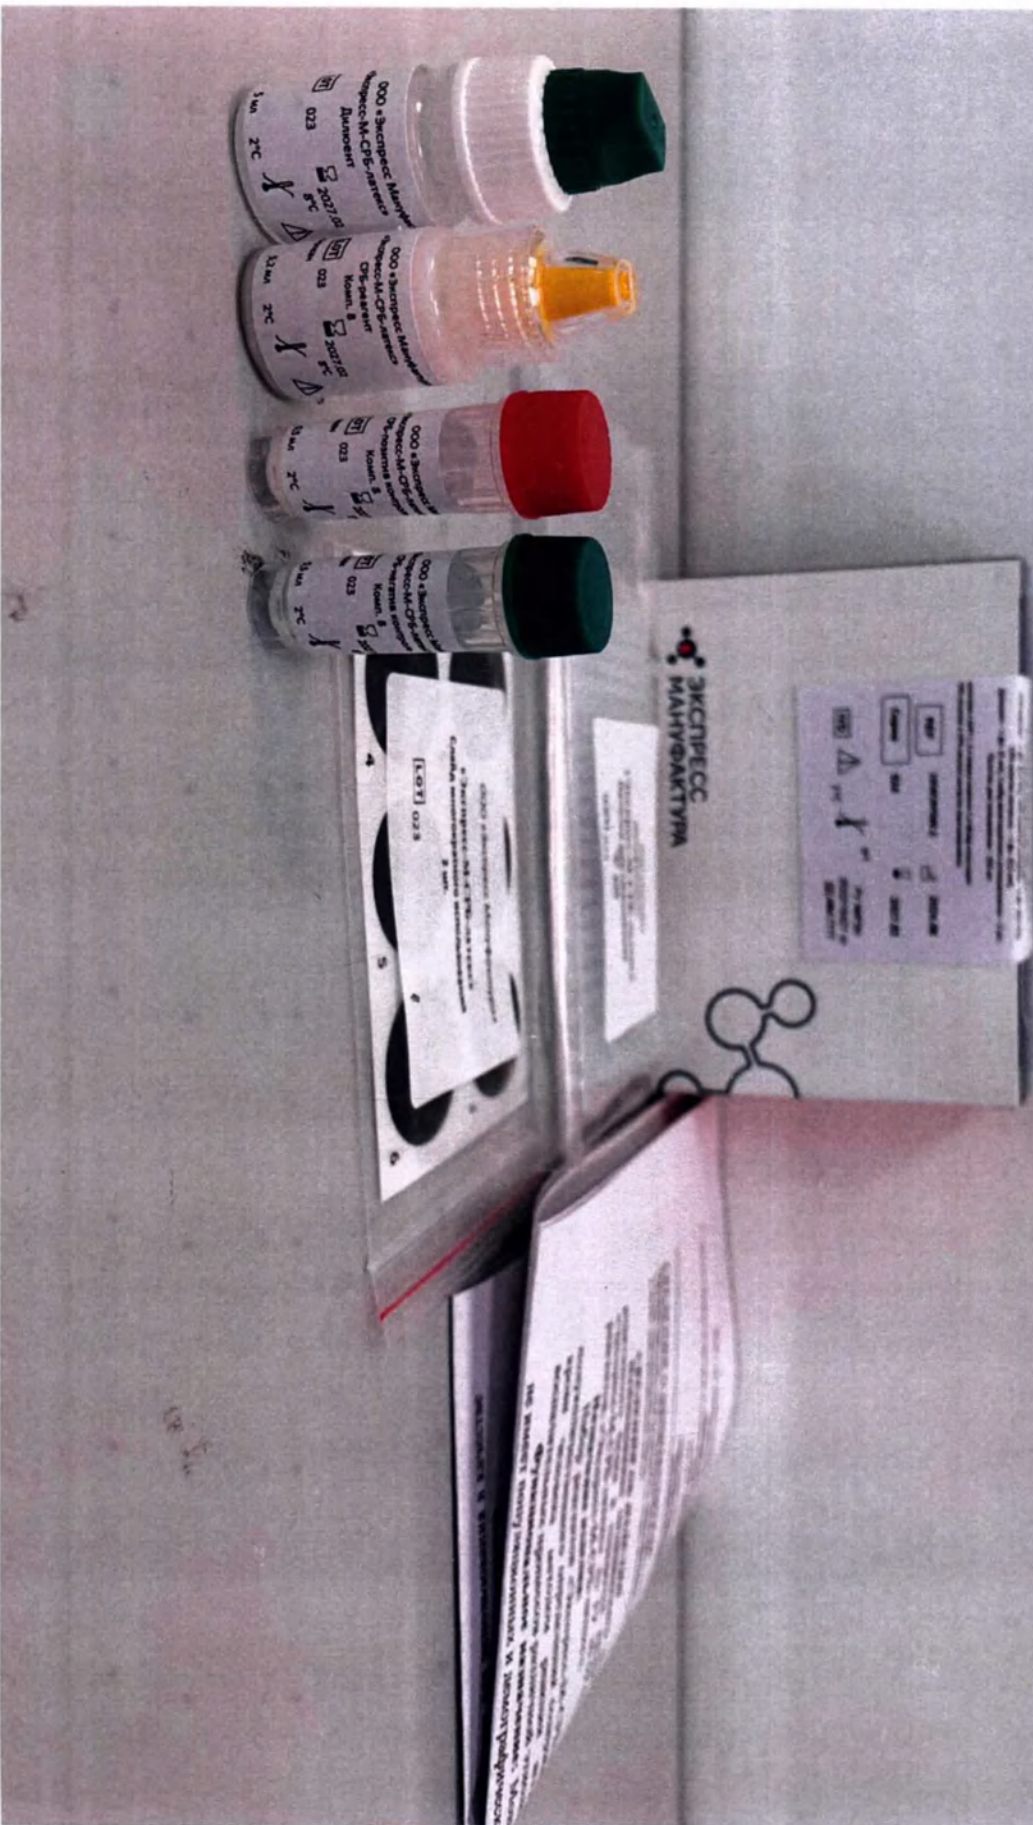

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения

Набор реагентов для определения С-реактивного белка в
сыворотке крови человека методом латексной
агглютинации «Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024

Комплект 8 (500 определений)

СРБ-реагент - 1 фл. (5,2 мл), СРБ-позитивный контроль - 1 фл. (0,5 мл),
СРБ-негативный контроль - 1 фл. (0,5 мл),
Выявитель - 1 фл. (5 мл), Слайды многоразовного использования - 2 шт.,
Палочка для смешивания - 1 шт.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

ООО «Экспресс
Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»
Палочка для смешивания

250

LOT 023

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-СРБ-латекс»
Слайд многоразовного использования
2 шт.

LOT 023

Кат. № 1050CRP IVD Тама

Набор реагентов для
С-реактивного белка в сыворотке крови че-
ловека «Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024

100/200/250/400/500/1000
50/100/125/200/250/500

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, т. Н.
e-mail: info@expressm-test.ru



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия:
реактивного белка в сыворотке крови че-
ловека «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024
реагентов, «Экспресс-М-СРБ-латекс».



Назначение изделия:

Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-латекс» для
полуколичественного определения содержания
С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом реакции агглю-
тинации латекса.

Функциональное назначение: Мониторинг
не имеет популяционных и демографических

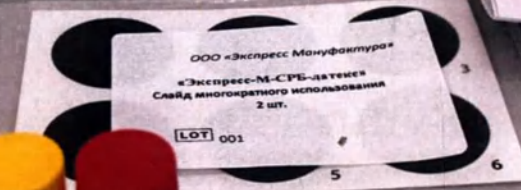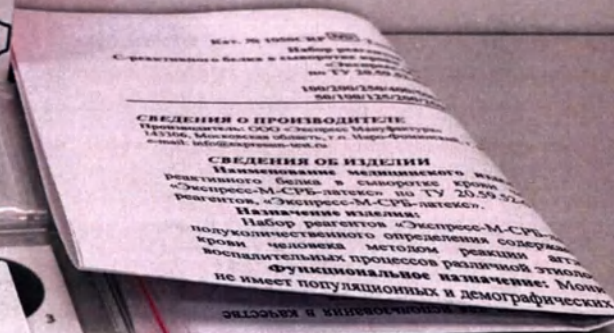



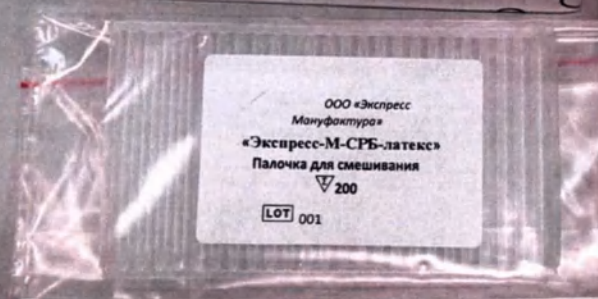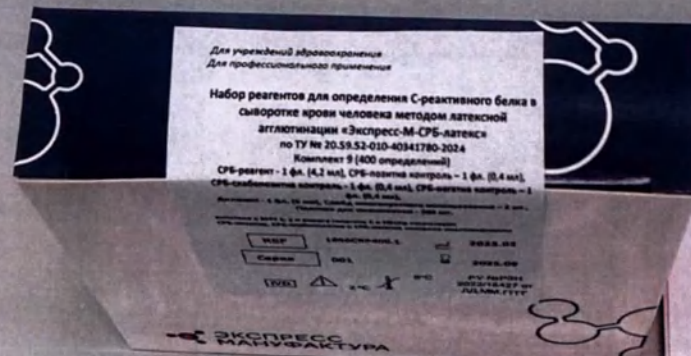

Кат. № 1050CRP **IVD** Только
Набор реагентов для
С-реактивного белка в сыворотке крови человека
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024
100/200/250/400/500/550/1000/125/200/2500

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Н.
e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024, реагентов, «Экспресс-М-СРБ-латекс».


Назначение изделия:


Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-латекс» предназначен для полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации.

Функциональное назначение:

Мониторинг воспалительных процессов различной этиологии. Не имеет популяционных и демографических различий.

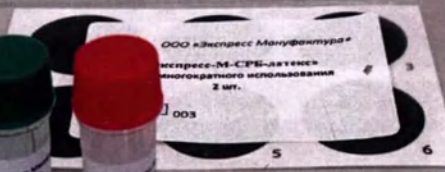

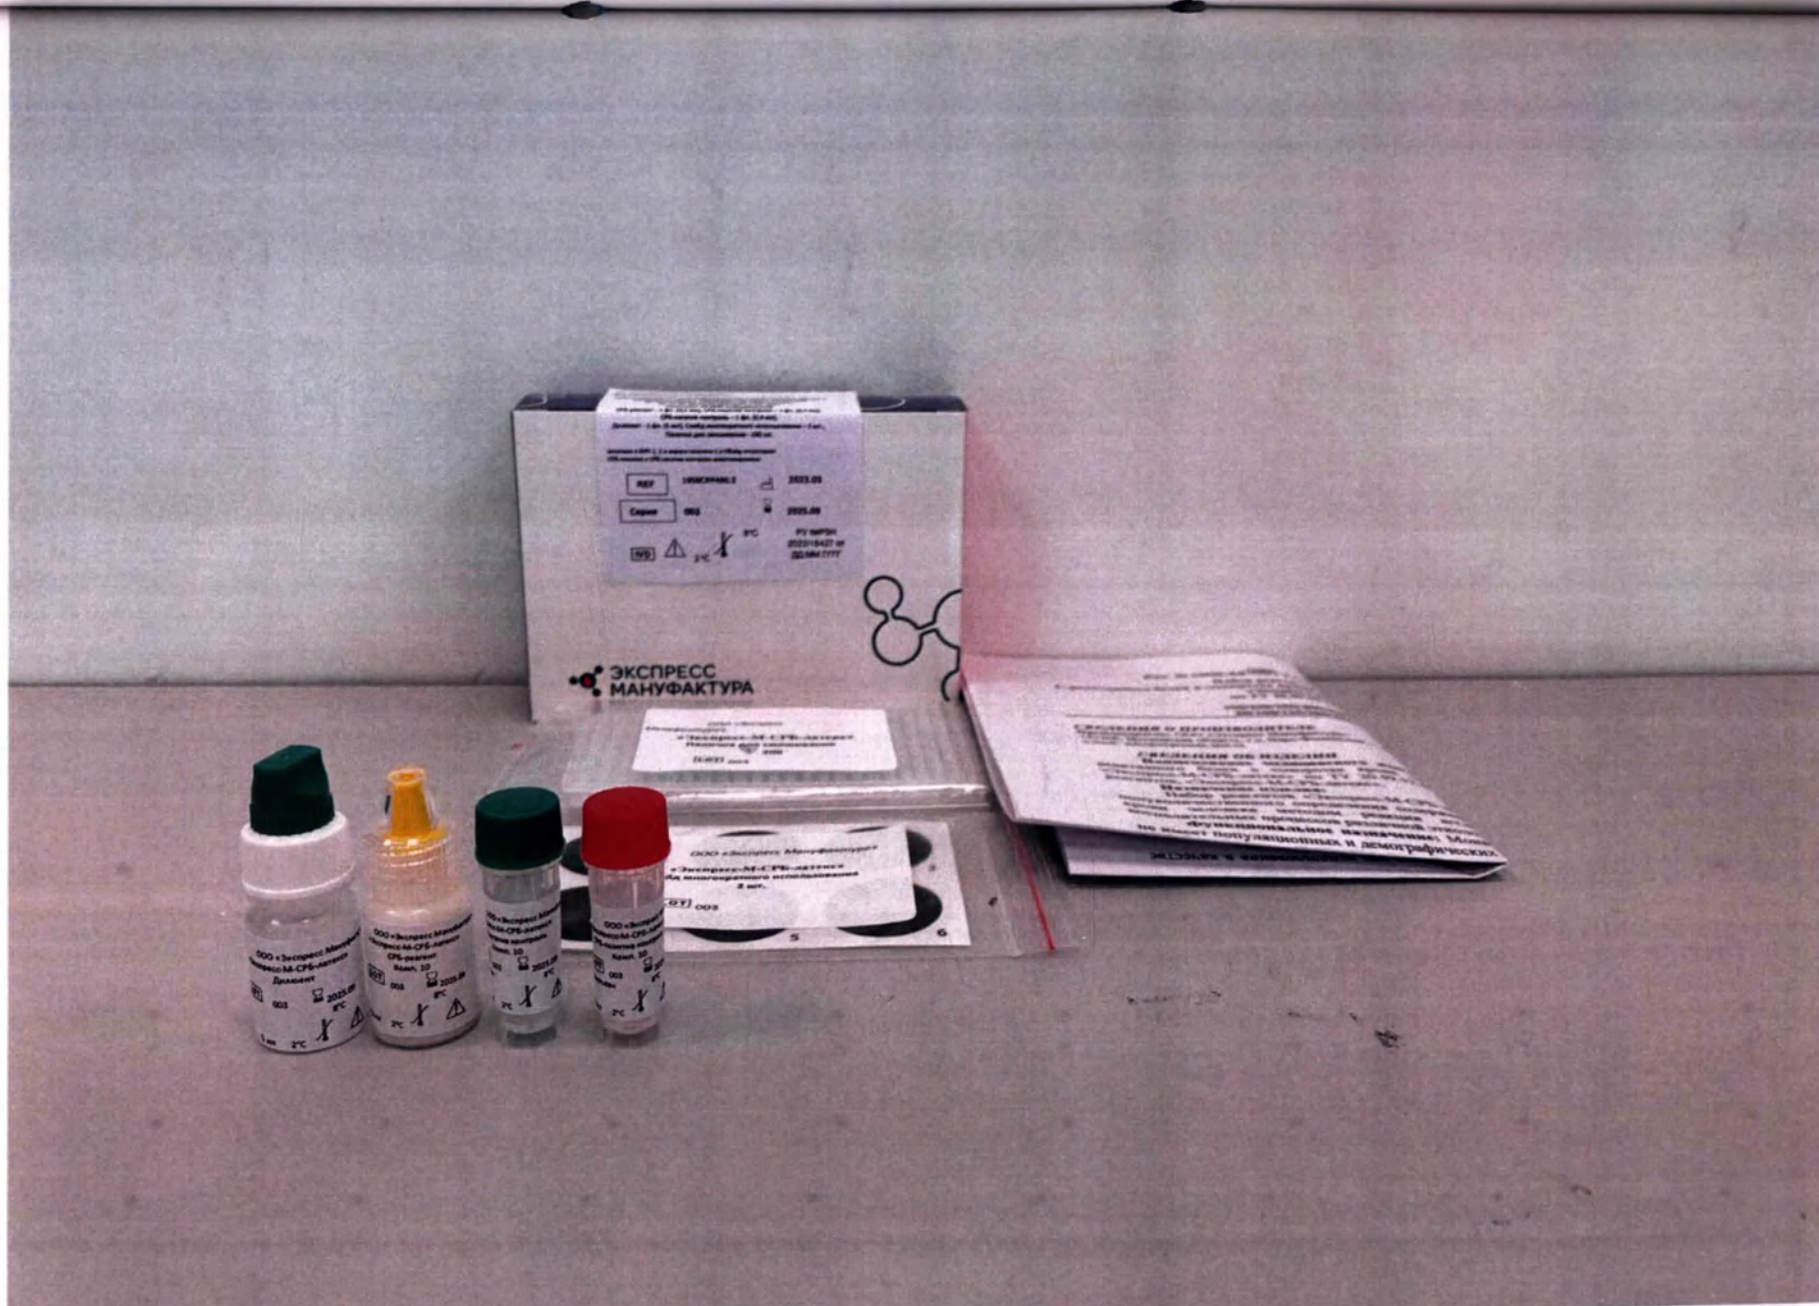


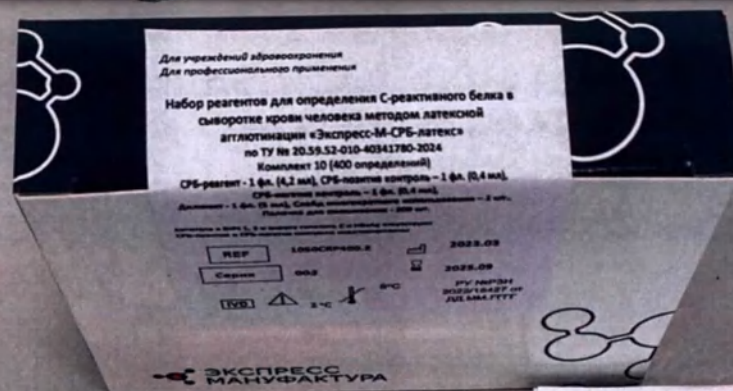



Кат. № 1050CRP VD Только
 Набор реагентов для
 С-реактивного белка в сыворотке крови че
 «Экспресс-М-
 по ТУ 20.59.52-010
 100/200/250/400/500/
 50/100/125/200/250/



СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
 143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Н
 e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия
 реактивного белка в сыворотке крови че
 «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-0
 реагентов, «Экспресс-М-СРБ-латекс».

Назначение изделия:
 Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-ла
 полуколичественного определения содержа
 крови человека методом реакции аггл
 воспалительных процессов различной этиолог
 Функциональное назначение: Мониторинг
 не имеет популяционных и демографических

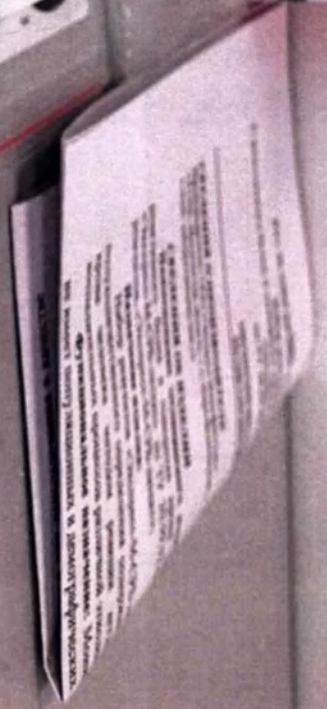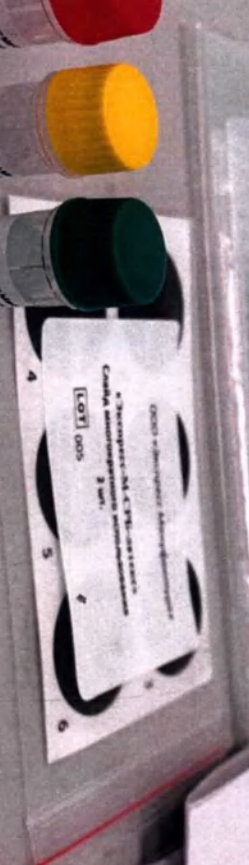

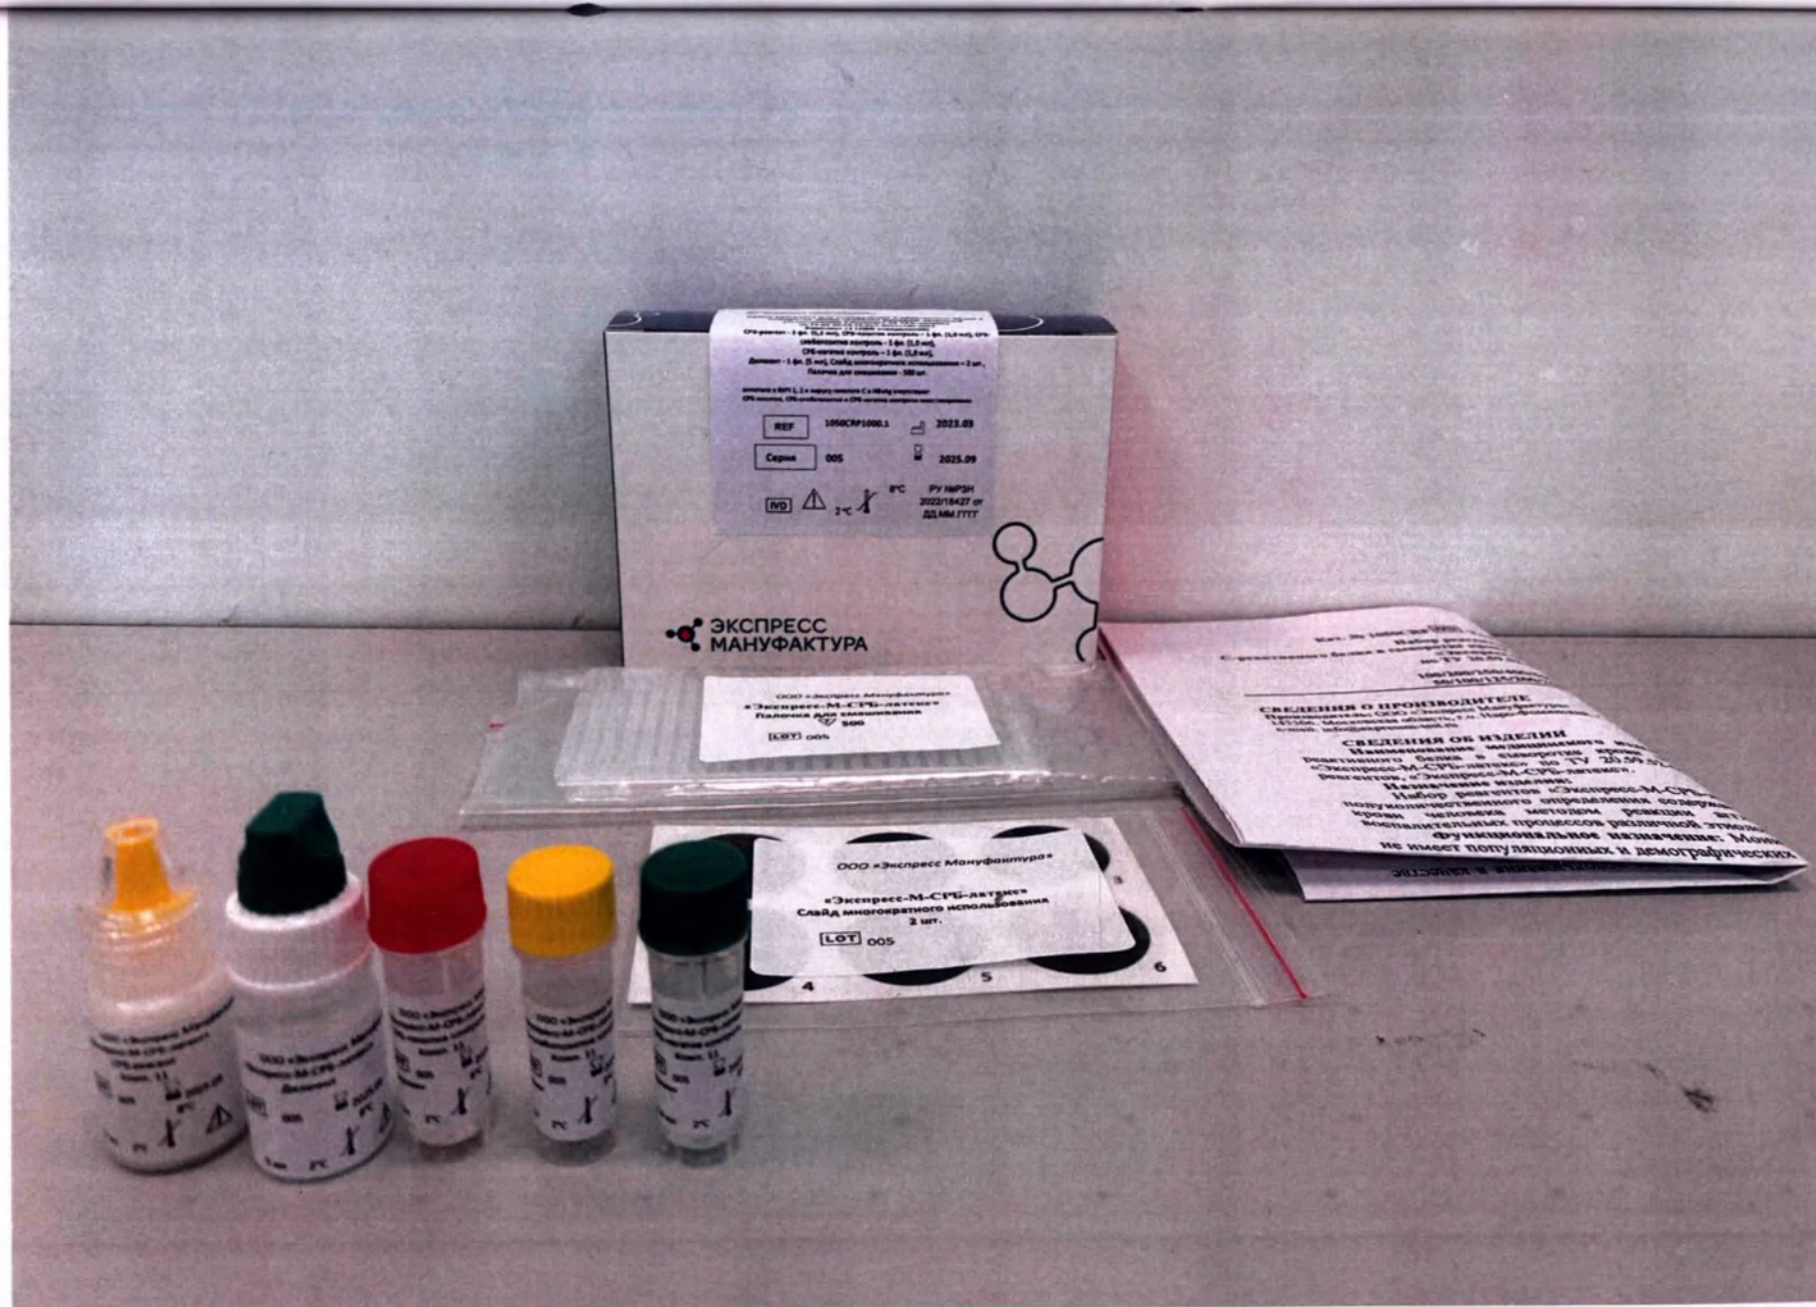


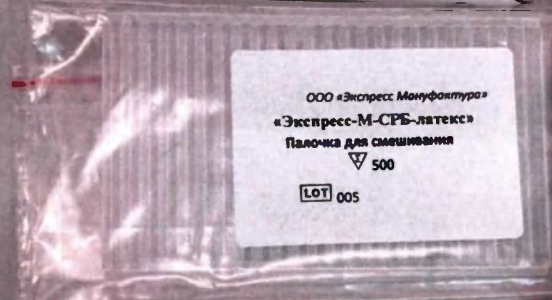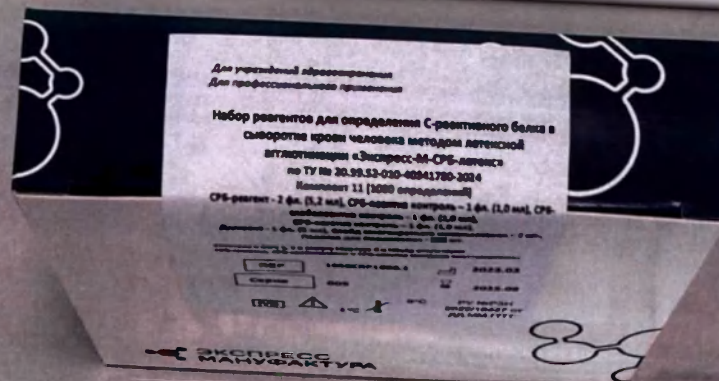

Кат. № 1050CRP **IVD** Товар
Набор реагентов
 С-реактивного белка в сыворотке крови человека
 «Экспресс-М-СРБ-латекс»
 по ТУ 20.59.52-010-40041780-3024
 100/200/250/400/500/1000
 50/100/125/200/250/400

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
 143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Истринское
 e-mail: info@express-test.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40041780-3024.
 Назначение изделия: Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-латекс» для полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации. Применяется для диагностики воспалительных процессов различной этиологии.
 Функциональное назначение: Мониторинг воспалительных процессов. Не имеет популяционных и демографических различий.

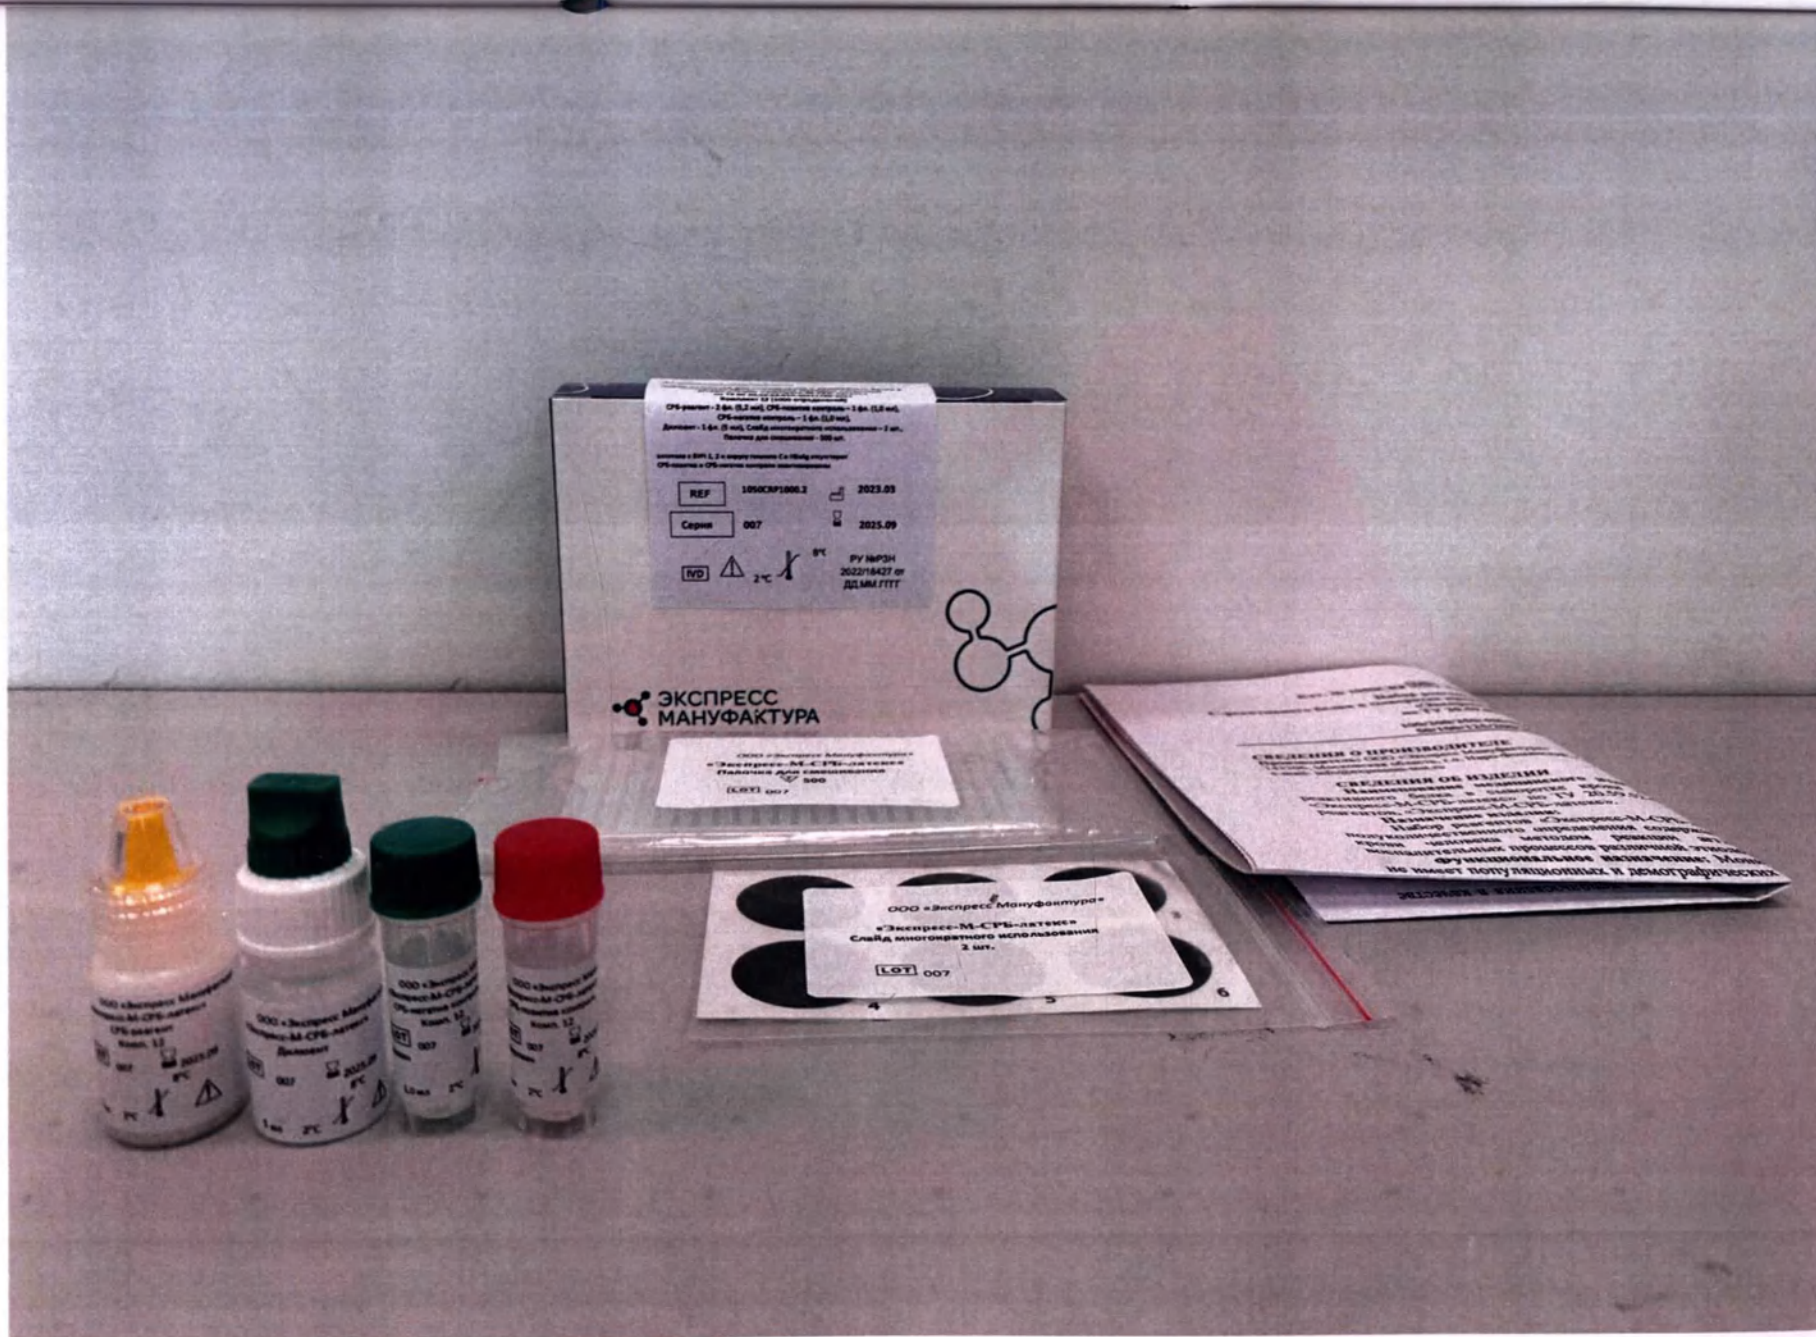




ООО ЭКСПРЕСС
МАНИФАКТУРА

Сертификат
№ 1234567890
Дата: 12.12.2023
Выдан: ООО ЭКСПРЕСС МАНИФАКТУРА
Содержимое: 12 шт.

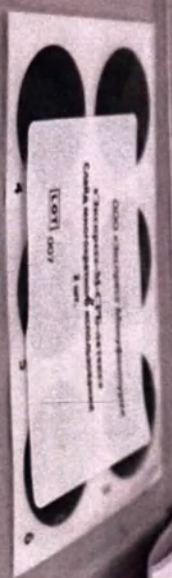

Сертификат
№ 1234567890
Дата: 12.12.2023
Выдан: ООО ЭКСПРЕСС МАНИФАКТУРА
Содержимое: 12 шт.

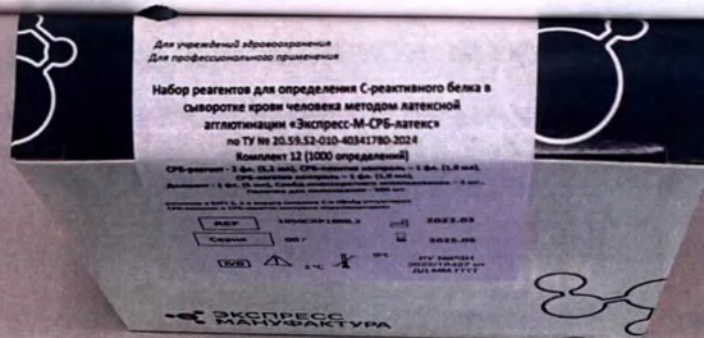




Кат. № 1050CRP **IVD** Только
Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024
 100/200/250/400/500/1000
 50/100/125/200/250/500


СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
 143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминское, ул. Мухоморова, д. 1
 e-mail: info@expressm-test.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом латексной агглютинации «Экспресс-М-СРБ-латекс» по ТУ 20.59.52-010-40341780-2024.
Назначение изделия: Набор реагентов «Экспресс-М-СРБ-латекс» предназначен для полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации.
Функциональное назначение: Мониторинг воспалительных процессов различной этиологии.
 Не имеет популяционных и демографических особенностей.


1. Флакон с СРБ-реагентом

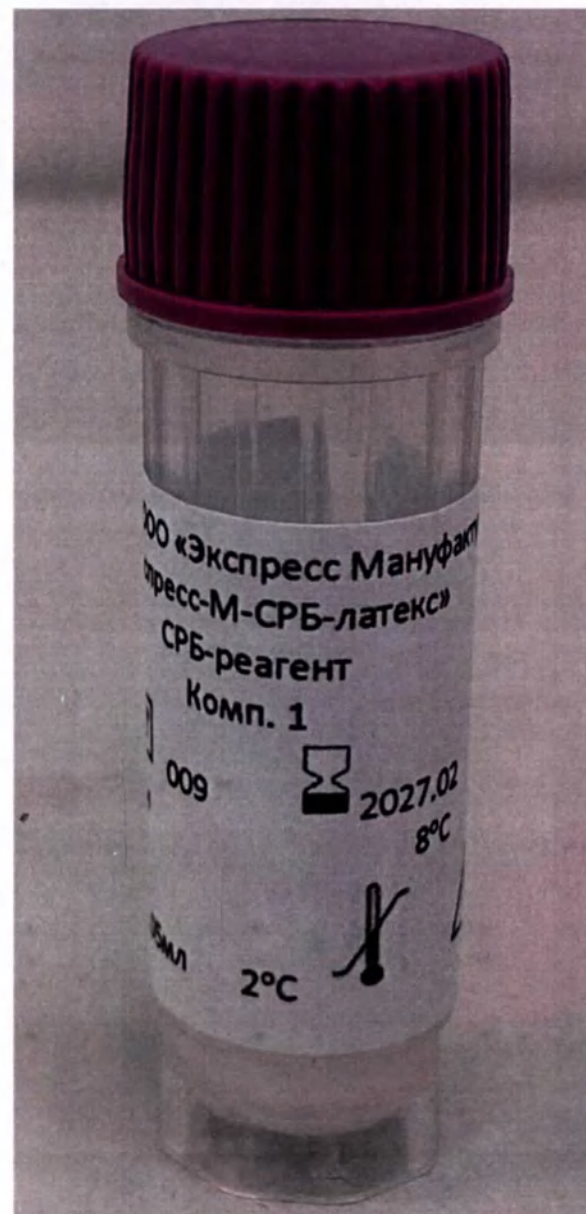

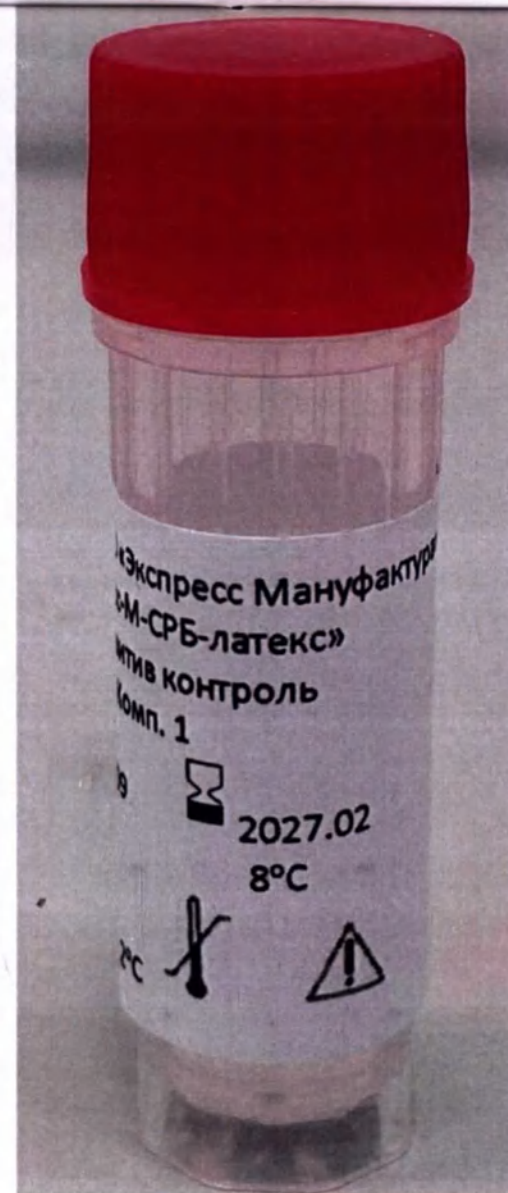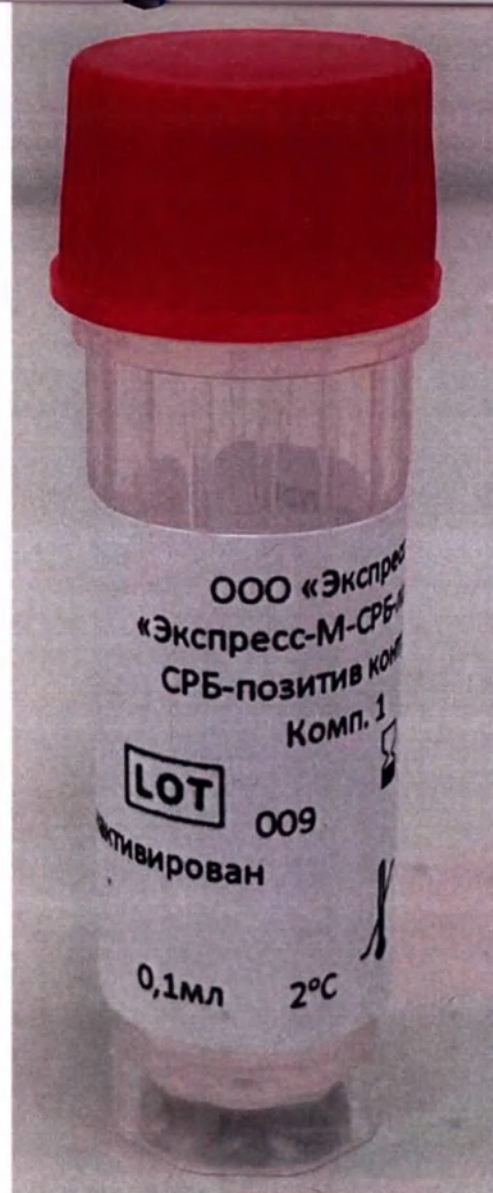


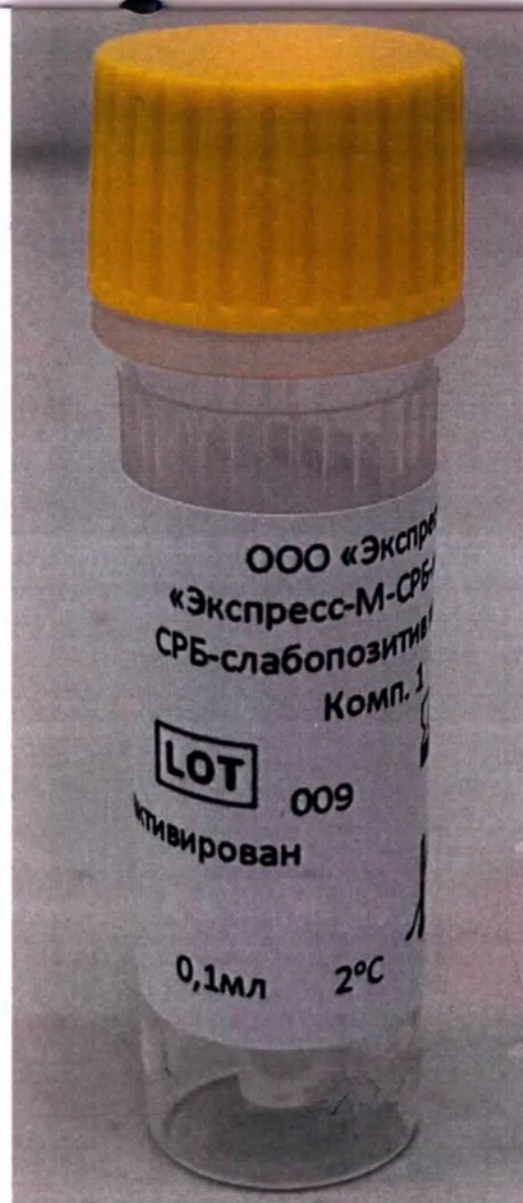

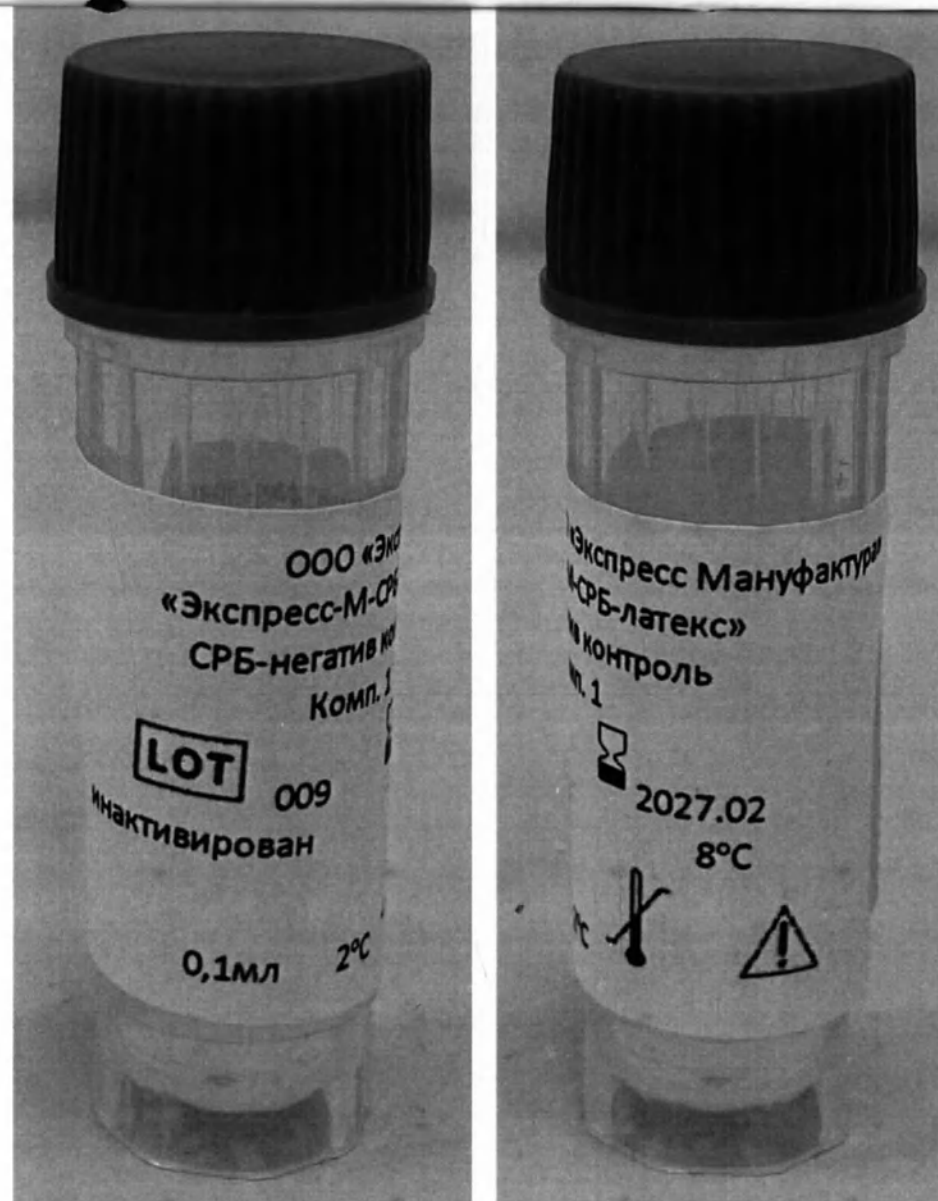

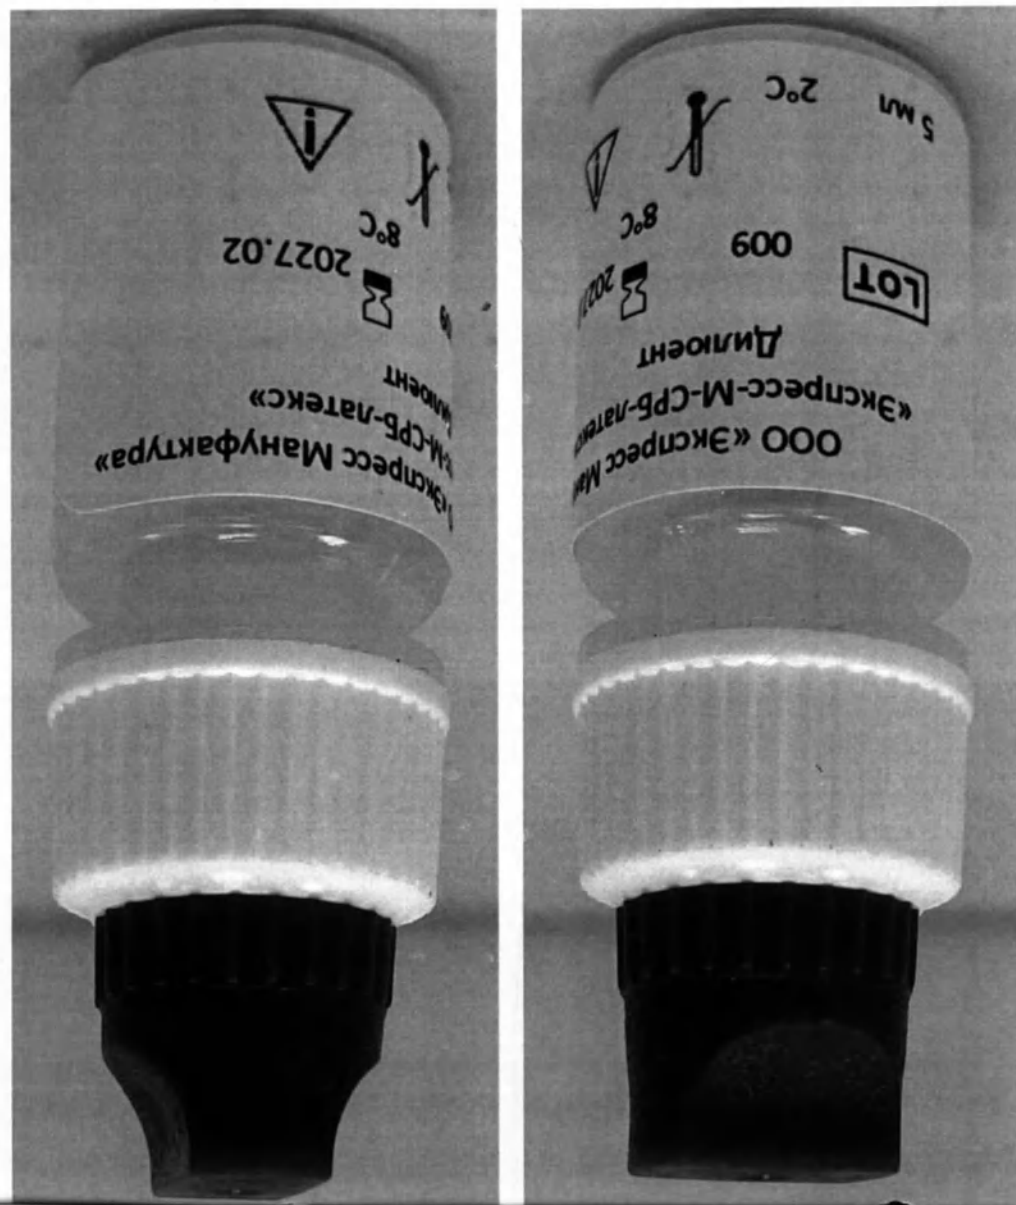



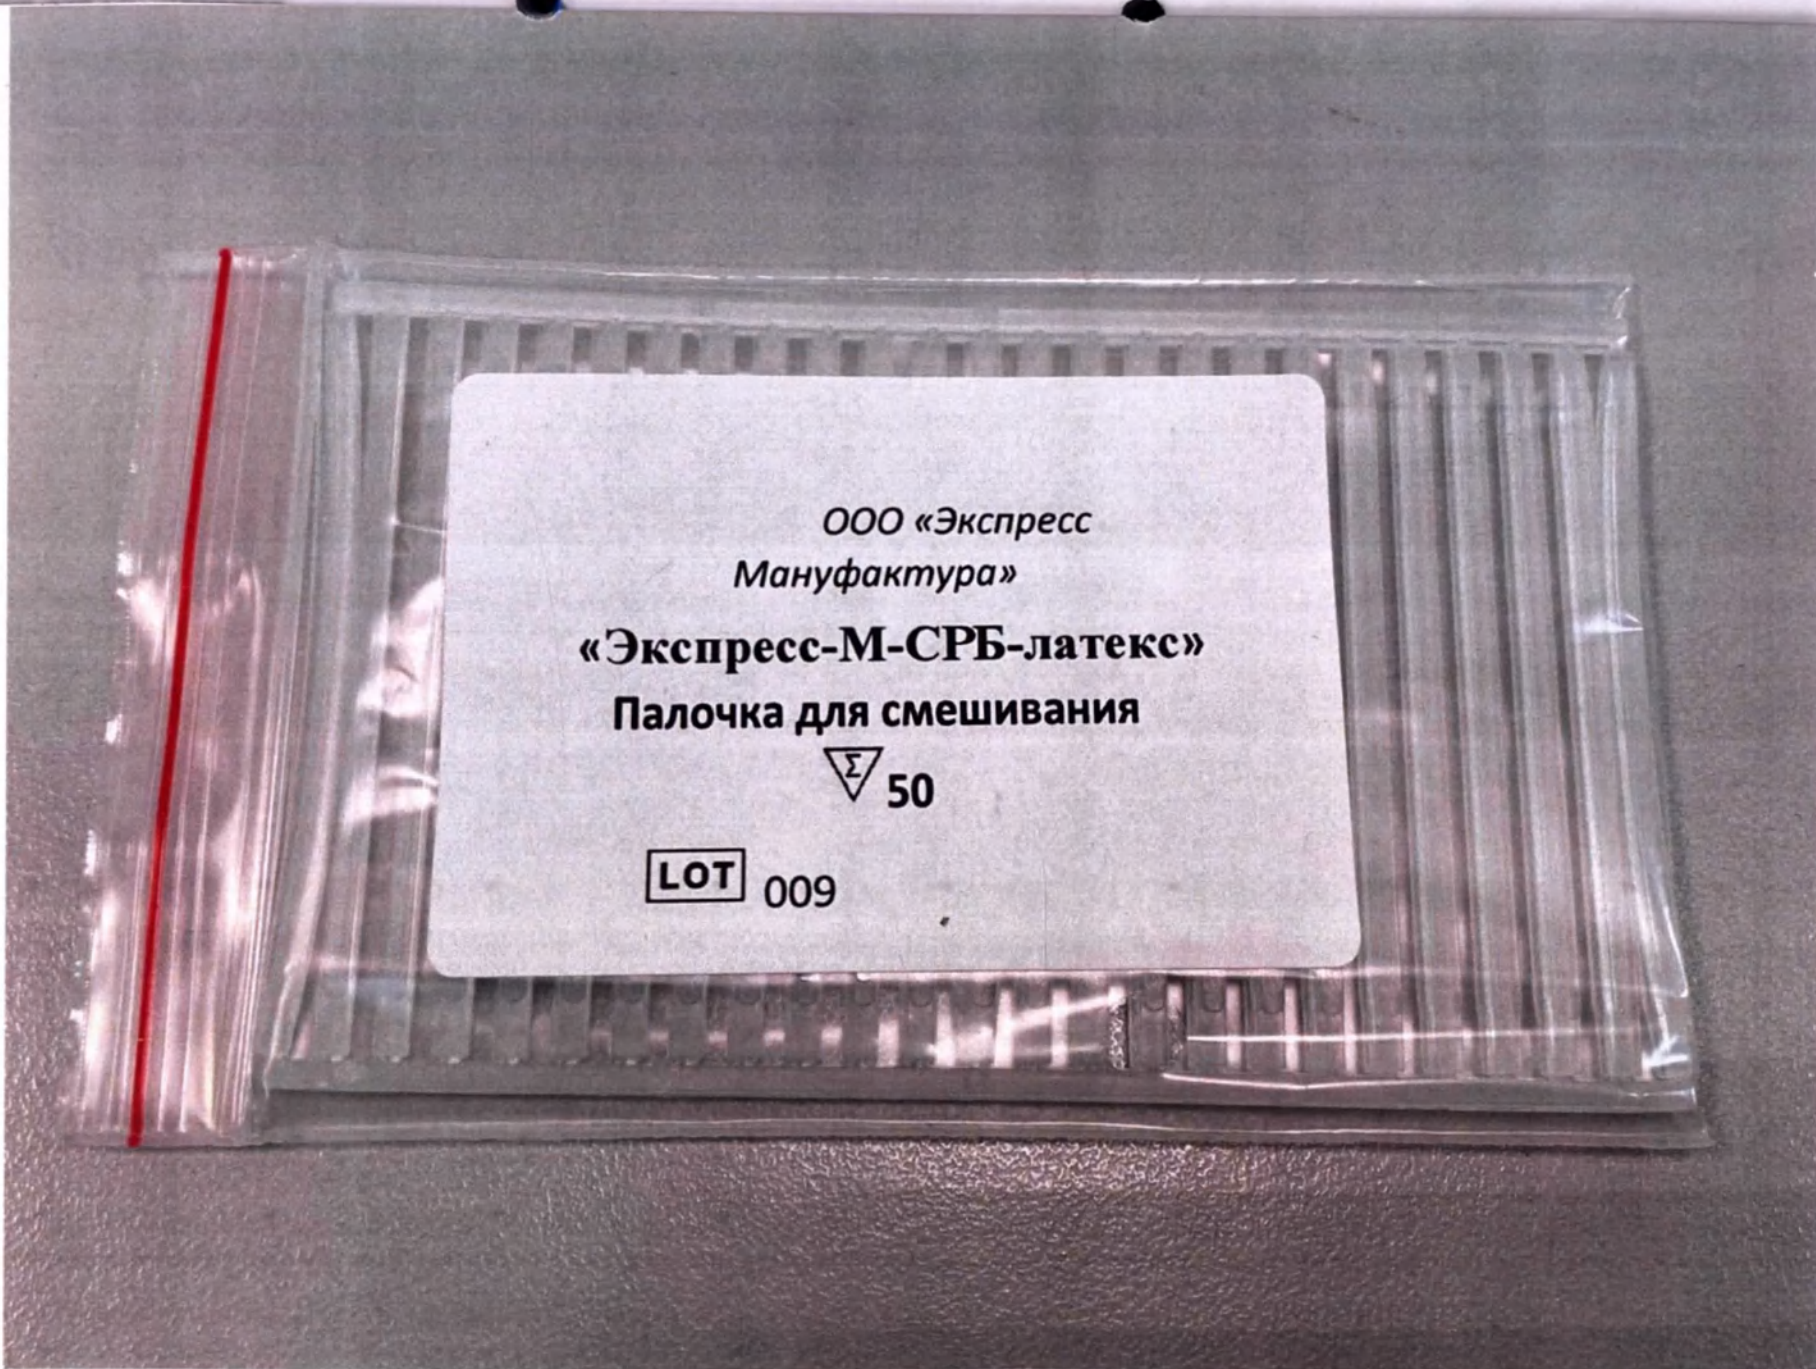

СРБ-реагент - 1 фл. (1,05 мл), СРБ-позитив контроль - 1 фл. (0,1 мл),
СРБ-слабопозитив контроль - 1 фл. (0,1 мл),
СРБ-негатив контроль - 1 фл. (0,1 мл),
Дилуэнт - 1 фл. (5 мл), Слайд многократного использования - 1 шт.,
Палочка для смешивания - 50 шт.

антитела к ВПЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
СРБ-позитив, СРБ-слабопозитив и СРБ-негатив контроли инаktivированы

REF

1050CRP100.1



2024.08

Серия

009



2027.02

IVD



2°C



8°C

РУ №РЗН
2022/18427 от
ДД.ММ.ГГГГ

 **ЭКСПРЕСС
МАНУФАКТУРА**



ООО «Экспресс Мануфактура»



143306, Московская область, г.о. Наро-
Фоминский, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина,
д. 28, помещ. 50



+7 495-19-0000-5
+7-985-57-2233-0



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru





+7 495-19-0000-5
+7 985-57-2233-0
info@expressm-test.ru
www.expressm-test.ru
143306, Московская область, г. Наро-Фоминский, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50



ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский,
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50
Набор реагентов для определения С-реактивного белка
в сыворотке крови человека методом латексной агглютинации
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024

Серия

003



2023.03.



2025.09.

2°C



8°C

2 шт

Масса нетто: 302 г

Масса брутто: 922 г

Масса нетто потребительской упаковки: 86 г





ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский,
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50
Набор реагентов для определения С-реактивного белка
в сыворотке крови человека методом латексной агглютинации
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024

Серия

003



2023.03.



2025.09.

2°C  8°C

40 шт

Масса нетто: 6040 г

Масса брутто: 6930 г

Масса нетто потребительской упаковки: 86 г





ООО «Экспресс Мануфактура»
143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский,
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50

Набор реагентов для определения С-реактивного белка
в сыворотке крови человека методом латексной агглютинации
«Экспресс-М-СРБ-латекс»
по ТУ № 20.59.52-010-40341780-2024

Серия

003



2023.03.



2025.09.

2°C



8°C

200 шт

Масса нетто: 30200 г

Масса брутто: 31260 г

Масса нетто потребительской упаковки: 86 г






Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

55 листа

Генеральный директор

ООО "Экспресс Мануфактура"



 Киреев И.В.