


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального
бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-
исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

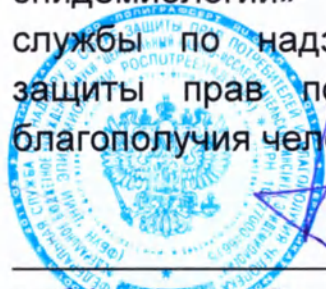


В.Г. Акимкин


« 03 » декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР
в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене MSM6 методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав:

- К+ ДНК LCT 1 0,2 мл x 1 шт.
- К+ ДНК LCT 2 0,2 мл x 1 шт.
- К+ ДНК LCT 3 0,2 мл x 1 шт.
- К- 0,2 мл x 1 шт.
- ОКО 1,2 мл x 1 шт.



Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

- Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1 1 шт.
- Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

- Инструкция по применению 1 шт.
- Паспорт качества набора реагентов 1 шт.
- Вкладыш к набору реагентов 1 комплект
- Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:



- ПЦР-смесь-FL LCT 0,6 мл x 1 шт.
- ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.
- Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

REF S-4461-1

LOT ДД.ММ.ГГ

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

ТУ 20.59.52-446-01897593-2022



Регистрационный номер:



МСМ6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

Форма 1, до вскрытия внешней упаковки (коробка), часть 2 из 2



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru




Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене МСМ6 методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2



Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL LCT 0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

-24 °C -16 °C



ПЦР-смесь-FL LCT

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК LCT 1 0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 2 0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 3 0,2 мл x 1 шт.
К- 0,2 мл x 1 шт.
ОКО 1,2 мл x 1 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1

1 шт.

Руководство оператора

1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению

1 шт.

Паспорт качества набора реагентов

1 шт.

Вкладыш к набору реагентов

1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов

1 шт.

REF S-4461-1



ГГГГ-ММ-ДД

LOT ДД.ММ.ГГ



ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

ТУ 20.59.52-446-01897593-2022

Регистрационный номер:



MCM6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

после вскрытия внешней упаковки (коробка), часть 2 из 2



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@rcrt.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL LCT 0,6 мл x 1 шт.

Поллимераза (TaqF) 0,3 мл x 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК LCT 1 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК LCT 2 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК LCT 3 0,2 мл x 1 шт.

К- ОКО 1,2 мл x 1 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе ман на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Программное обеспечение AmpliSens® LCT SNP Soft версия 1

Руководство оператора

Эксплуатационная документация на бумажном носителе

и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению

Паспорт качества набора реагентов

Вкладыш к набору реагентов

Краткое руководство к набору реагентов

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 комплект 1 шт.

REF S-4461-1

LOT ДД.ММ.ГГ

Самостоятельно на основании жила № 212724, № 321480

ТУ 20.514.52 446 0189/593 2022 Регистрационный номер


ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД




MSM6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

Форма 1, до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock), часть 1 из 2



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235
в гене *MSM6* методом ПЦР в режиме реального времени
АмплиСенс® LCT-SNP-FL


Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав:

К+ ДНК LCT 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 3	0,2 мл x 1 шт.
К-	0,2 мл x 1 шт.
ОКД	1,2 мл x 1 шт.

2°C



Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL LCT	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

ИДР S-4461-1


LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.59.52-446-01897593-2022

Регистрационный номер:

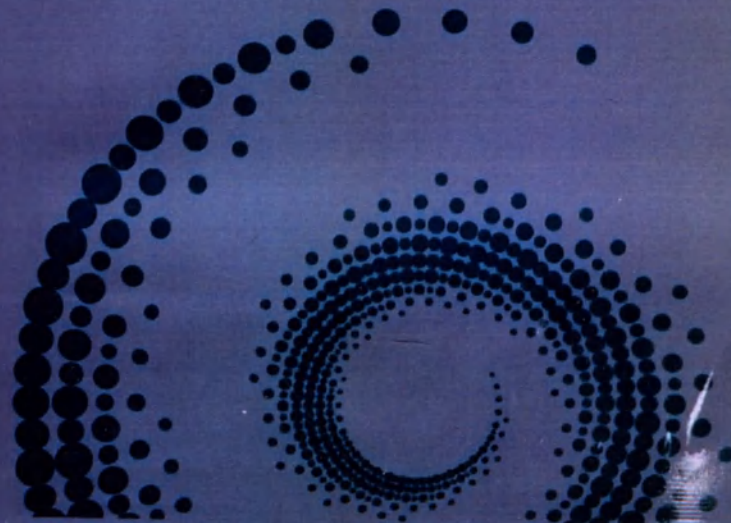

МСМ6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

Форма 1, после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock), часть 1 из 2



АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

Форма 1
LCT-SNP-FL
LCT-SNP-FL

1. Назначение набора реагентов
2. Состав набора реагентов
3. Условия хранения
4. Срок годности
5. Меры предосторожности
6. Порядок использования
7. Информация о производителе

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени



АмплиСенс®

Краткое руководство
набор реагентов
АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1
LCT-SNP-FL
LCT-SNP-FL

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

ИД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

ФОРМЫ ЦИТИЗАЦИИ

ВЛОДАВШ

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

Информация для загрузки информации, включая и интерпретацию результатов

ПО АмплиСенс® LCT-SNP-FL в. 1.0.3

Ссылка для загрузки информации в ПО



ФОРМЫ ЦИТИЗАЦИИ

ВЛОДАВШ

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

Информация для загрузки информации, включая и интерпретацию результатов

ПО АмплиСенс® LCT-SNP-FL в. 1.0.3

Ссылка для загрузки информации в ПО

Наименование	Единица измерения	Количество	Срок годности	Условия хранения
АмплиСенс® LCT-SNP-FL	мл	10	12 месяцев	2-8 °C

АмплиСенс®
набор реагентов для качественного определения генотипов по МСМ6 методу ПЦР в режиме реального времени

MCM6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

Форма 1, до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock), часть 2 из 2





Фотография Набора реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL, Форма 1, до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock), часть 1 из 2





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Погодинская, 3А
Москва, ул. Погодинская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 971-00-00, факс: (495) 971-5423
e-mail: amplisens@fsc.ru, www.amplisens.ru



Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав:
K+ ДНК LCT 1 0,2 мл x 1 шт.
K+ ДНК LCT 2 0,2 мл x 1 шт.
K+ ДНК LCT 3 0,2 мл x 1 шт.
K- 0,2 мл x 1 шт.
ONK 1,2 мл x 1 шт.


Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):
Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1 1 шт.
Руководство оператора 1 шт.
Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):
Инструкции по применению 1 шт.
Паспорт качества набора реагентов 1 комплект
Вкладыш к набору реагентов 1 шт.

Краткое руководство к набору реагентов
Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:
ПЦР-смесь-FL LCT 0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

REF S-4461-1
Свидетельство на товарный знак № 212726, № 321480
ТУ 20.59.52-446-01897593-2022



2-8 °C

Регистрационный номер: 

Форма 1

Набор реагентов	1 шт.
Паспорт качества	1 шт.
Вкладыш к набору реагентов	1 шт.
ПЦР-смесь-FL LCT	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

MCM6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

Форма 1, до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock), часть 2 из 2



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
121123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL LCT	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК LCT 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 3	0,2 мл x 1 шт.
К	0,2 мл x 1 шт.
ОНО	1,2 мл x 1 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкции по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

REF S-4461-1

LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

ТУ 20.59.52-446 0189/593 2022

Регистрационный номер:

IVD

16 °C

-24 °C

ПЦР-смесь-FL LCT

55

QR code

MCM6 методом ПЦР в режиме реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL,

Форма 1, после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock), часть 2 из 2




Фотография реагентов, входящих в состав Набора реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме реального времени


АмплиСенс® LCT-SNP-FL, Форма 1, часть 1 из 2



АмплиСенс® LCT-SNP-FL Форма 1, часть 2 из 2

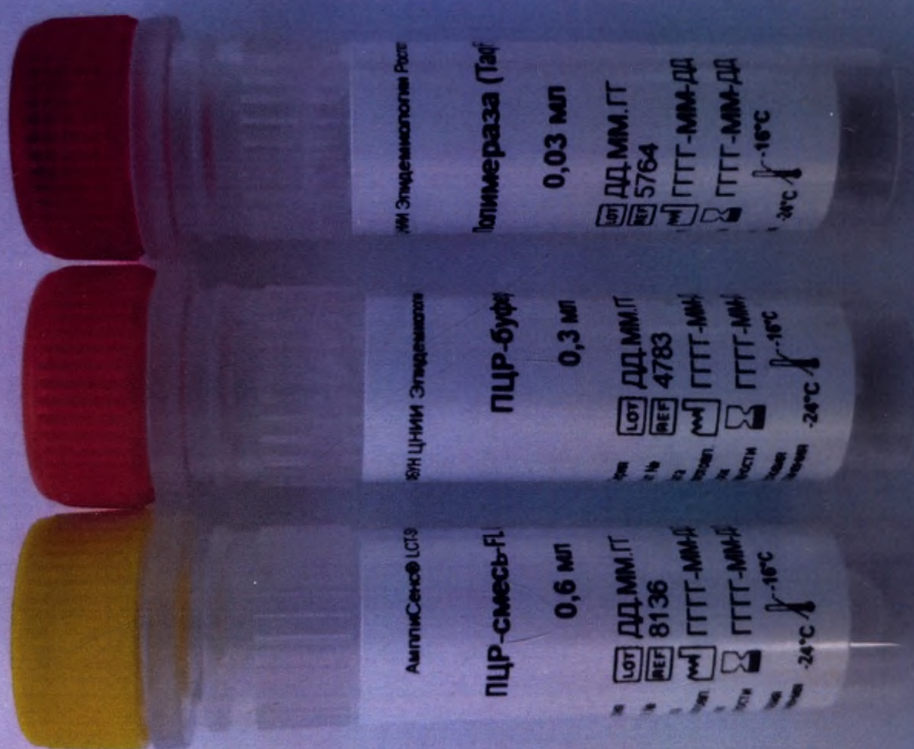

графия программного обеспечения AmpliSens® LCT-SNP Soft на электронном носителе Набора реагентов
качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме
реального времени АмплиСенс® LCT-SNP-FL, Форма 1*

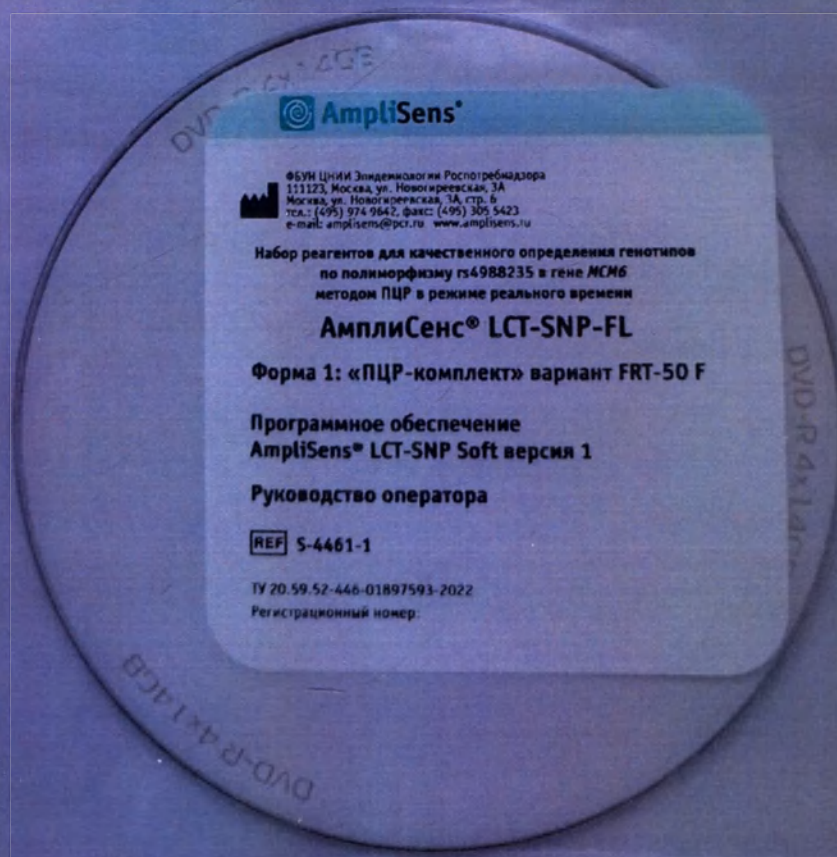

ставке на электронном носителе


Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 16
шестидеять лист 05

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

« 05 » 16 20 24 г.

А.О.Лисицына

м.п.

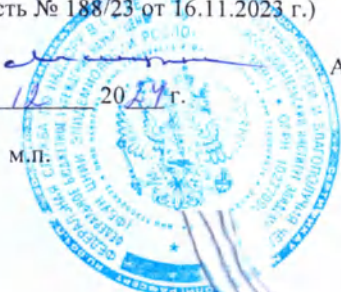

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека



В.Г. Акимкин

« 01 » декабря 2024 г.

Макет маркировки медицинского изделия

**Набор реагентов для качественного определения генотипов по
полиморфизму rs4988235 в гене *MCM6* методом ПЦР в режиме
реального**

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

На 4 листах

Маркировка набора реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (часть 1 из 2)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене MCM6 методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL


Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1



Часть 1. Состав:

К+ ДНК LCT 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК LCT 3	0,2 мл x 1 шт.
К-	0,2 мл x 1 шт.
ОКО	1,2 мл x 1 шт.



Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL LCT	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.59.52-446-01897593-2022

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав «ПЦР-комплекта» вариант FRT-50 F (часть 1 из 2)

Наименование реагента	Маркировка
К+ ДНК LCT 1	
К+ ДНК LCT 2	

K+ ДНК LCT 3	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора AmpliSens K+ ДНК LCT 3 0,2 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. MM Срок годности Условия хранения 2°C 8°C
K-	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора AmpliSens K- 0,2 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. MM Срок годности Условия хранения 2°C 8°C
ОКО	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора AmpliSens ОКО 1,2 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. MM Срок годности Условия хранения 2°C 8°C

Маркировка набора реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (часть 2 из 2)

AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974-9642, факс: (495) 305-5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs4988235 в гене MCM6 методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL LCT	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

K+ ДНК LCT 1	0,2 мл x 1 шт.
K+ ДНК LCT 2	0,2 мл x 1 шт.
K+ ДНК LCT 3	0,2 мл x 1 шт.
K-	0,2 мл x 1 шт.
ОКО	1,2 мл x 1 шт.

-24 °C -16 °C ПЦР-смесь-FL LCT

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):
Программное обеспечение AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1 1 шт.
Руководство оператора 1 шт.
Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):
Инструкция по применению 1 шт.
Паспорт качества набора реагентов 1 шт.
Вкладыш к набору реагентов 1 комплект
Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.59.52-446-01897593-2022 Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав «ПЦР-комплекта» вариант FRT-50 F (часть 2 из 2)

Наименование реагента	Маркировка
ПЦР-смесь-FL LCT	
ПЦР-буфер-С	
Полимераза (TaqF)	

Маркировка программного обеспечения



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
 Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
 e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для качественного определения генотипов
 по полиморфизму rs4988235 в гене *MSM6*
 методом ПЦР в режиме реального времени

АмплиСенс® LCT-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Программное обеспечение
AmpliSens® LCT-SNP Soft версия 1

Руководство оператора

REF

ТУ 20.59.52-446-01897 593-2022
 Регистрационный номер:

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Программное обеспечение маркируется в случае поставки на электронном носителе.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 4
сертификат лист а

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

А.О.Лисицына
« 05 » 12 2024 г.
М.П.

