

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Набор реагентов для быстрого количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay HbA1c Test Kit), в вариантах исполнения»

Рисунок 1. Общий вид МИ, вариант исполнения I

2

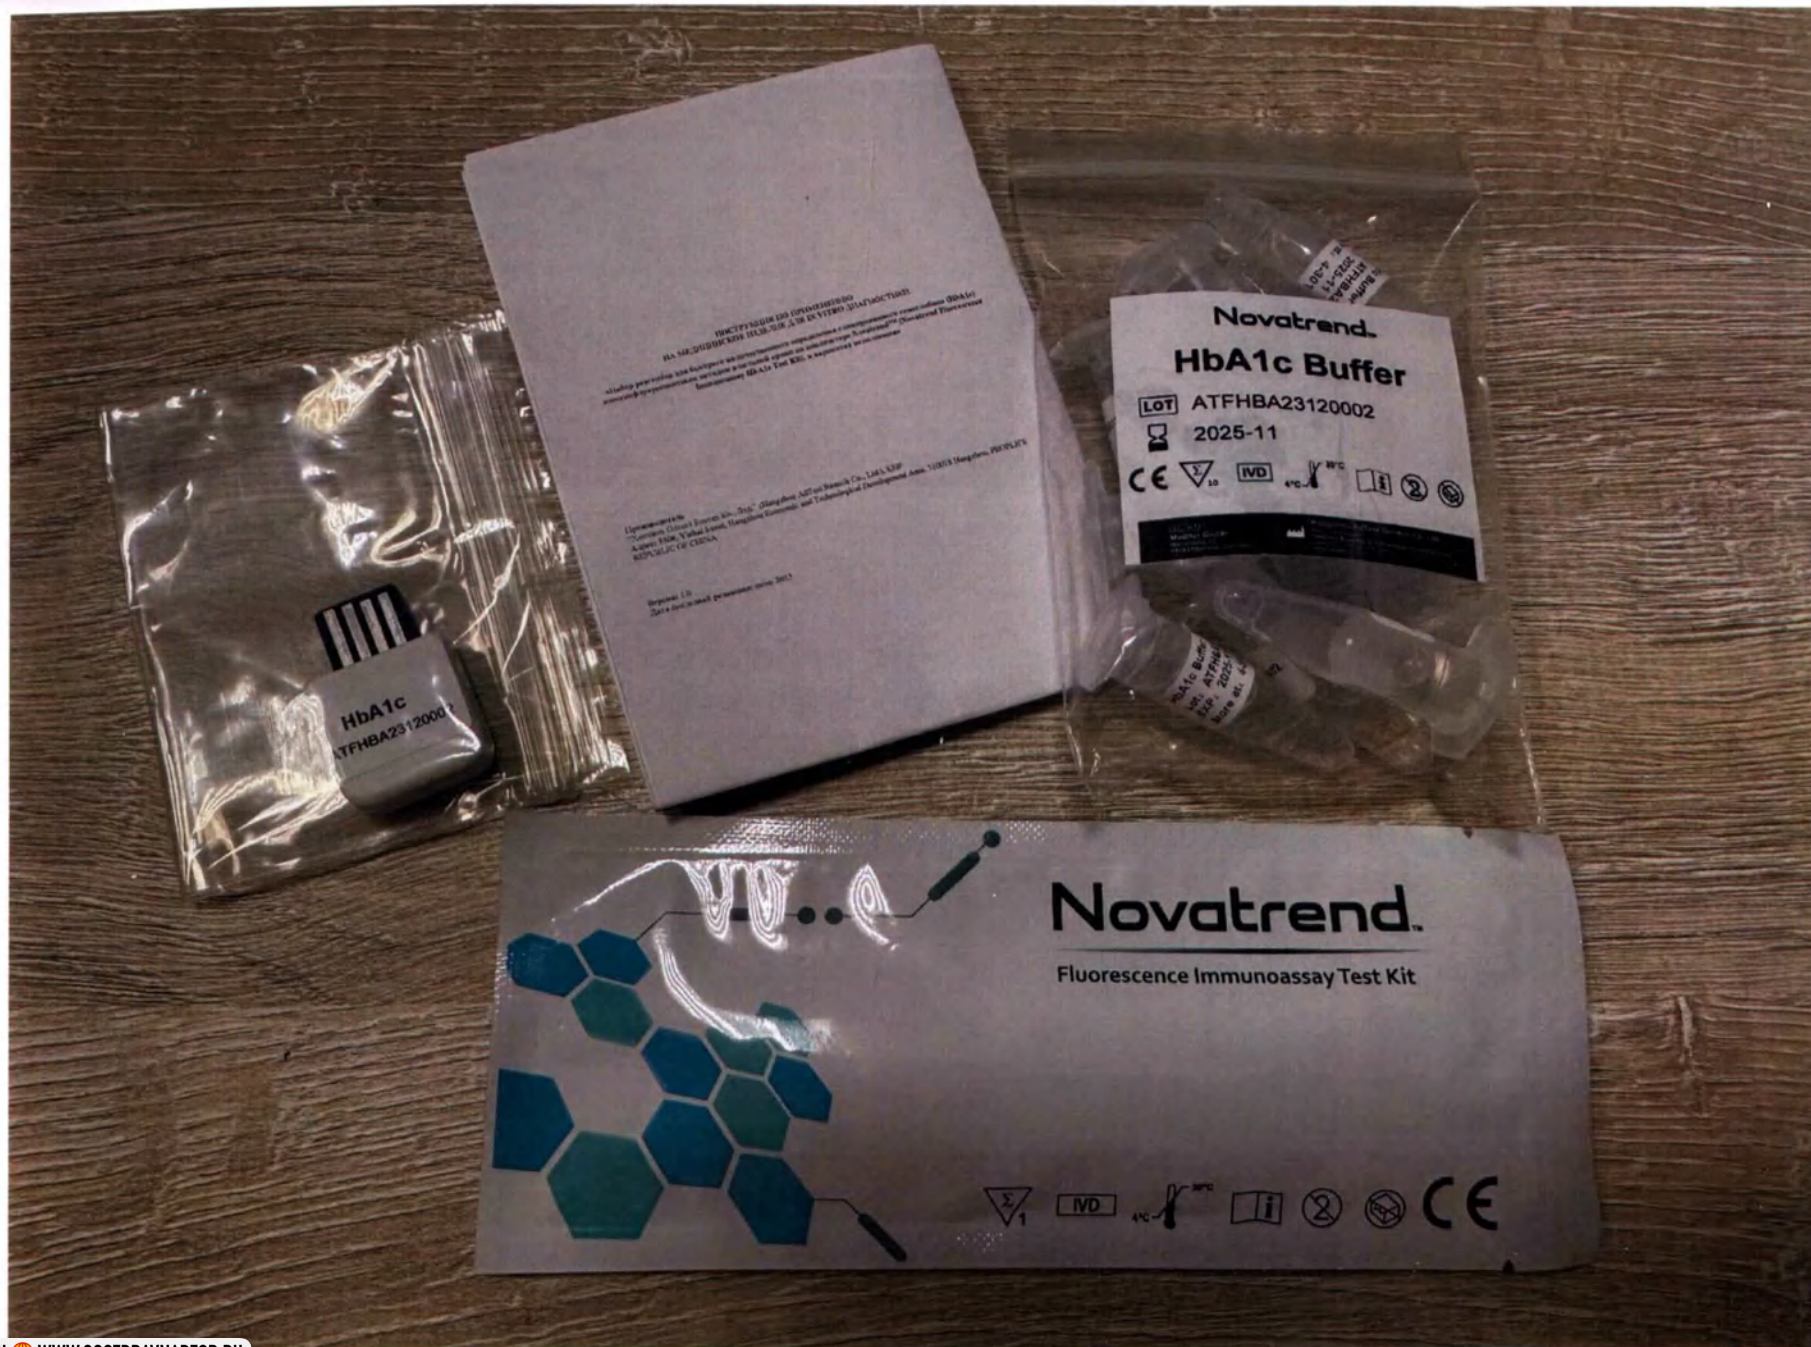




Рисунок 2 Общий вид МИ, вариант исполнения II



Рисунок 3. Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения I



Рисунок 4 Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения II



Рисунок 5. Первичная упаковка тест-кассеты (HbA1c Test Cassette), тест-кассета (HbA1c Test Cassette), осушитель

Рисунок 6. Первичная упаковка тест-кассеты (HbA1c Test Cassette)





Рисунок 7. Пробирка с буфером для разведения образцов



Рисунок 8. Вторичная упаковка буфера (zip-пакет)



Рисунок 9. Идентификационная карта (вид с двух сторон)



Рисунок 10. Первичная упаковка идентификационной карты (zip-пакет) (вид с двух сторон)

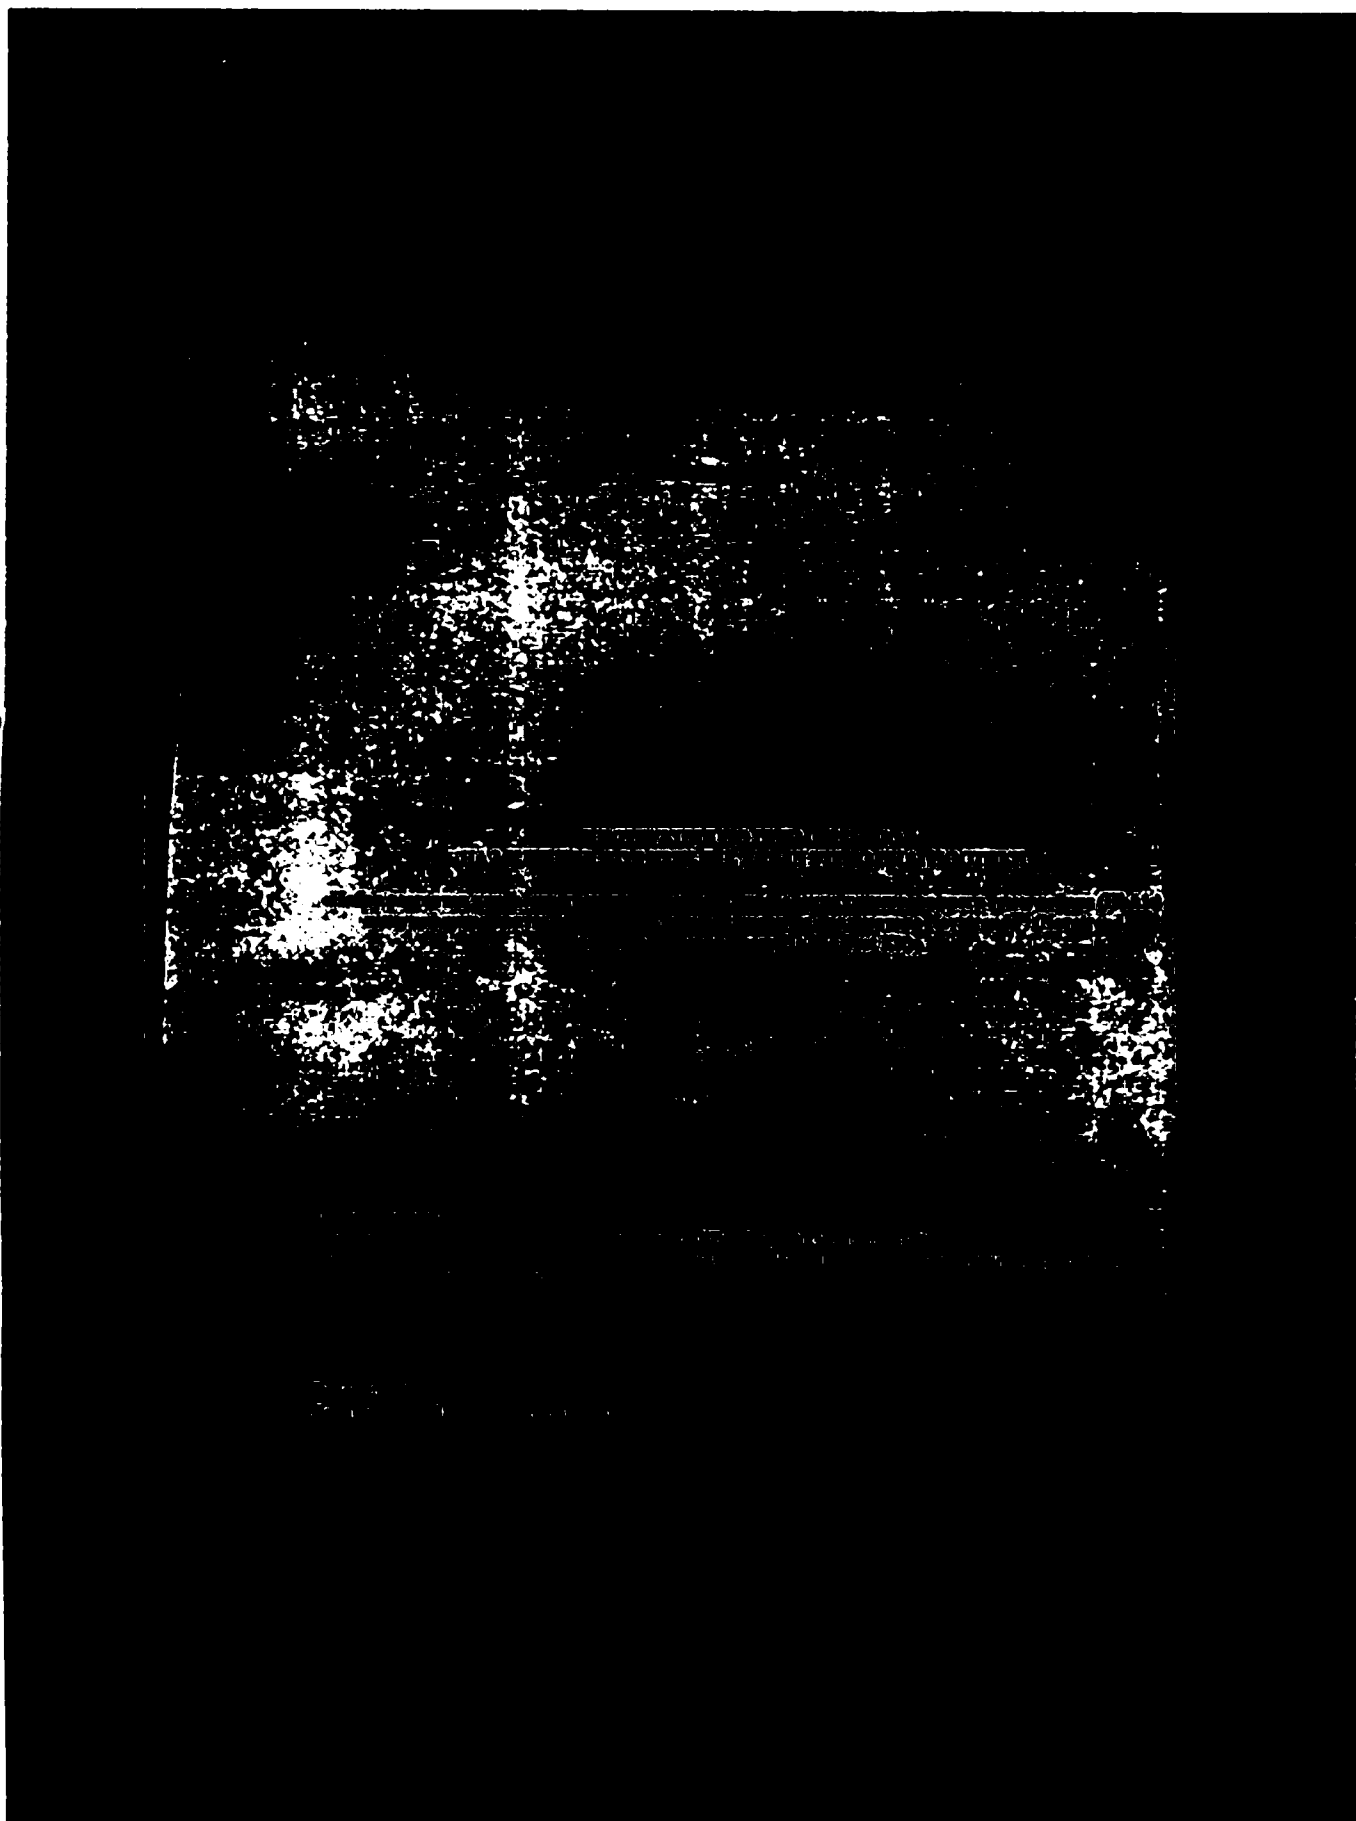


Рисунок 9. Инструкция по применению на медицинское изделие



ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д.В.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
12 ЛИСТОВ