УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Импэкс-Мед»
Холодкова В.И.

«04» июня 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»®

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Упаковка Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный (Тип ТМБР), Футляр классический.

- индивидуальная упаковка 2W:

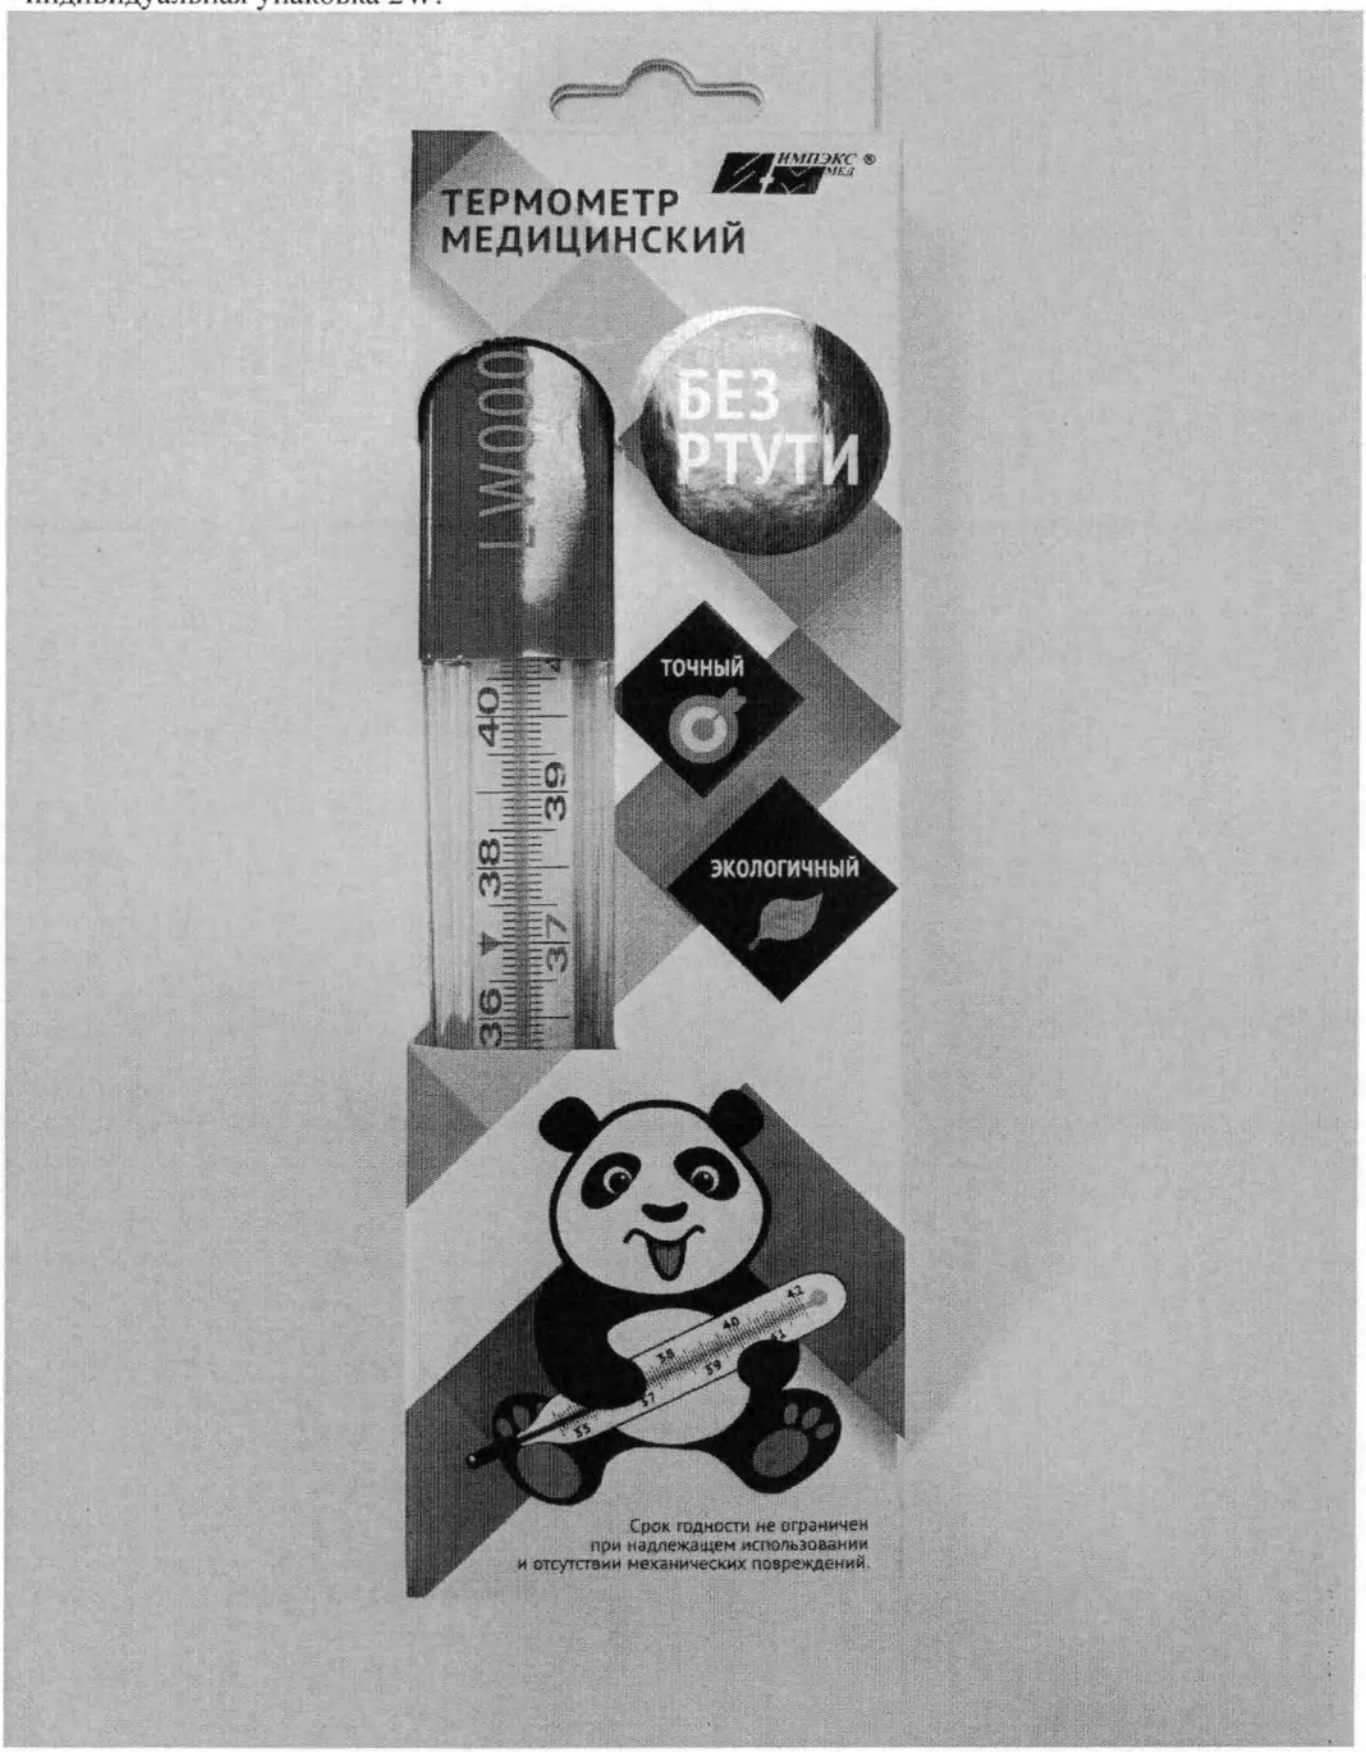

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный (Тип ТМБР) в составе:
1. Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный. 2. Футляр классический.
3. Инструкция по применению. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572 от 28.12.2021 года. Бессрочно.

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный.
Футляр классический. Инструкция по применению.

1 штука

Транспортирование и хранение. Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре внешней среды от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. **Осторожно стекло!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

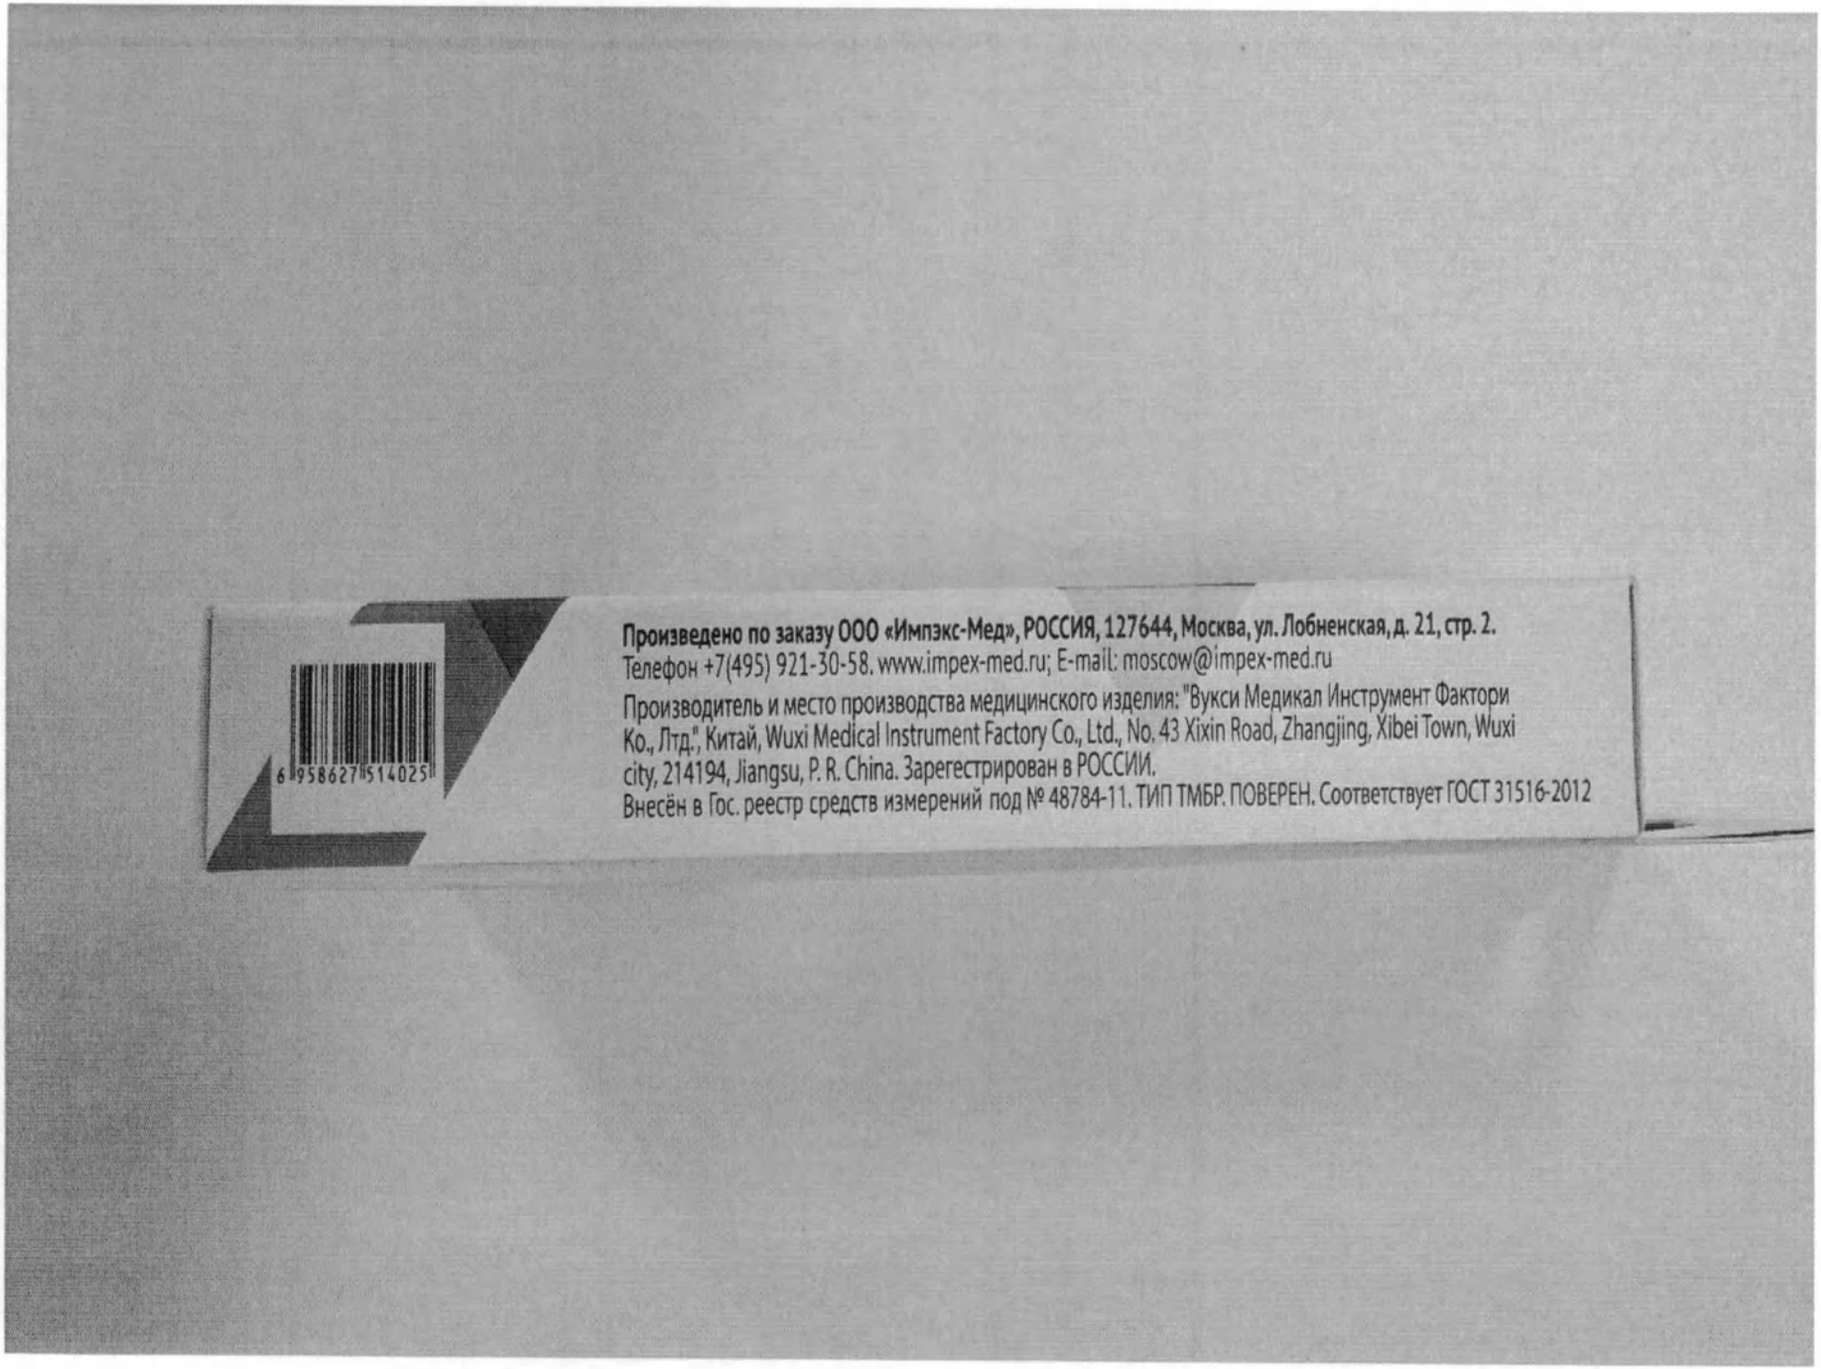

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

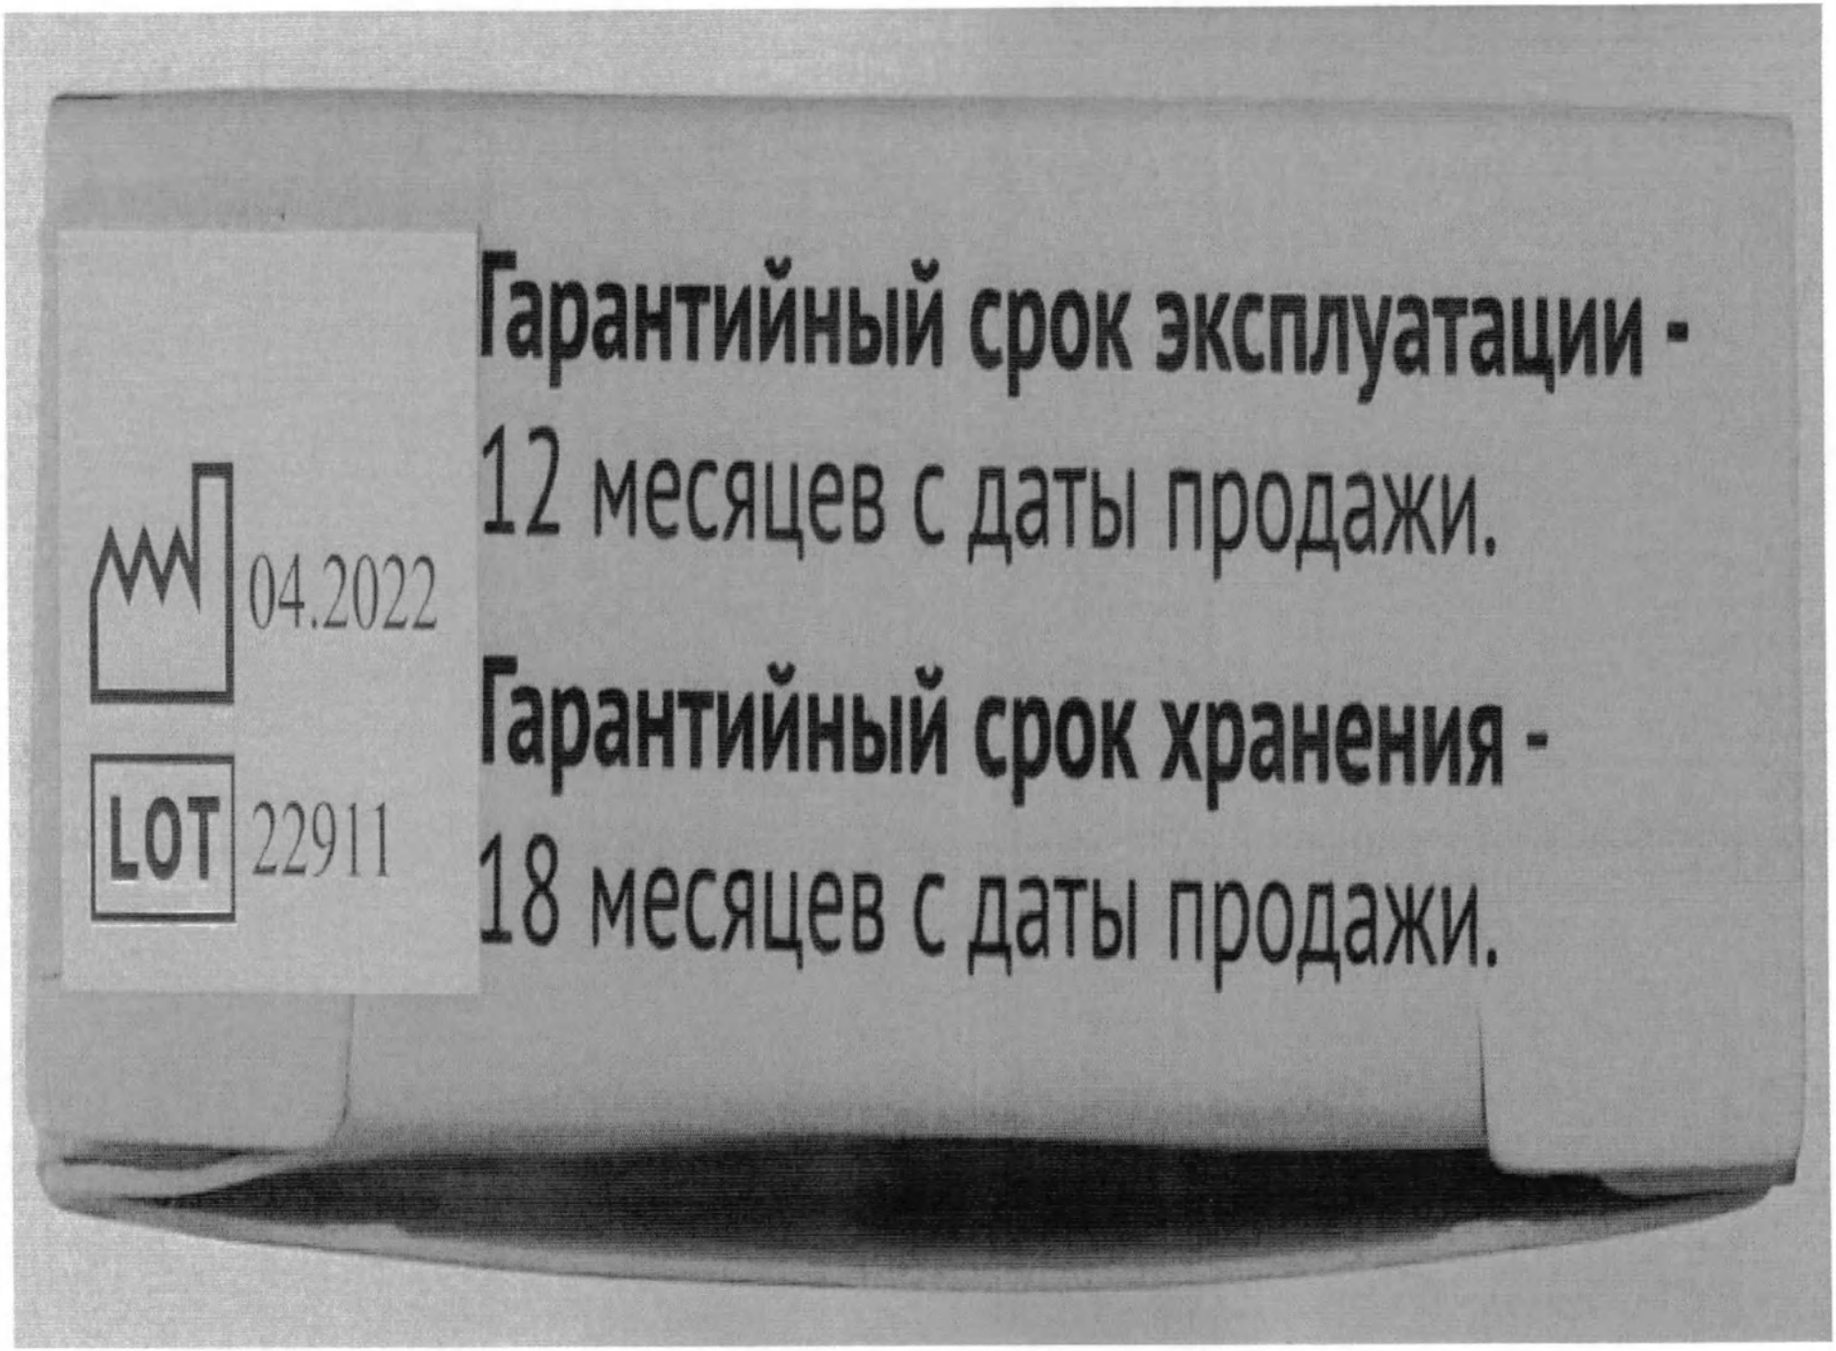

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Групповая упаковка 2W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

Срок годности не ограничен при надлежащем использовании и отсутствии механических повреждений

Зарегистрирован в РОССИИ
Внесён в Гос. реестр средств измерений
под № 48784-11. ПОВЕРЕН. ТИП ТМБР

Термометр соответсвует ГОСТ 31516-2012

Индивидуальная упаковка

БЕЗ РТУТИ

Произведено по заказу
ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ,
127644, Москва, ул. Лобненская,
д. 21, стр. 2.
Телефон +7(495) 921-30-58.
www.impex-med.ru;
E-mail: moscow@impex-med.ru

CE 1023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД ®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

БЕЗ РТУТИ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты продажи.

04.2022

LOT 22911

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

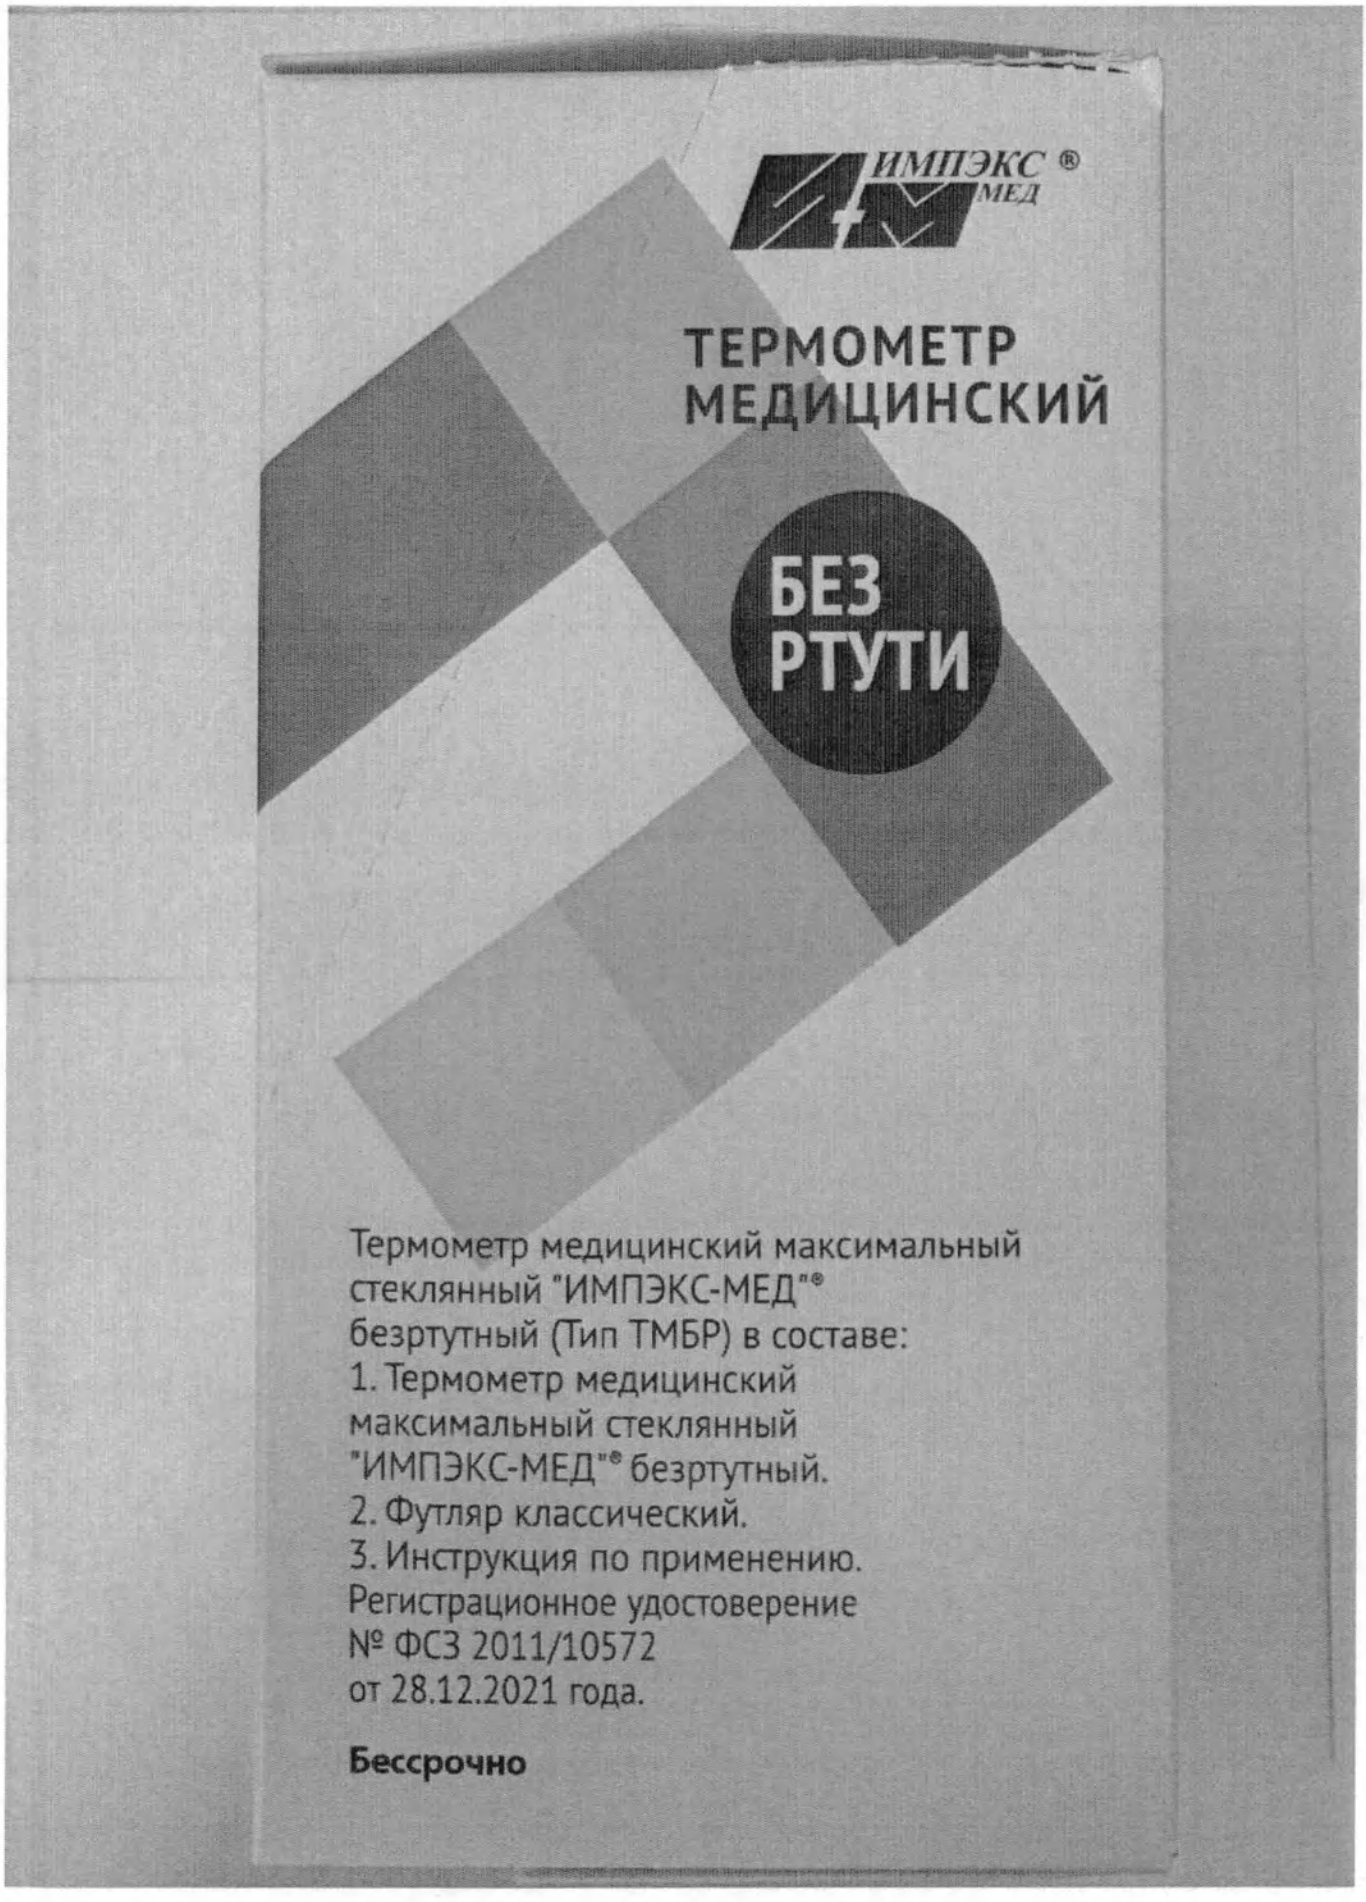

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

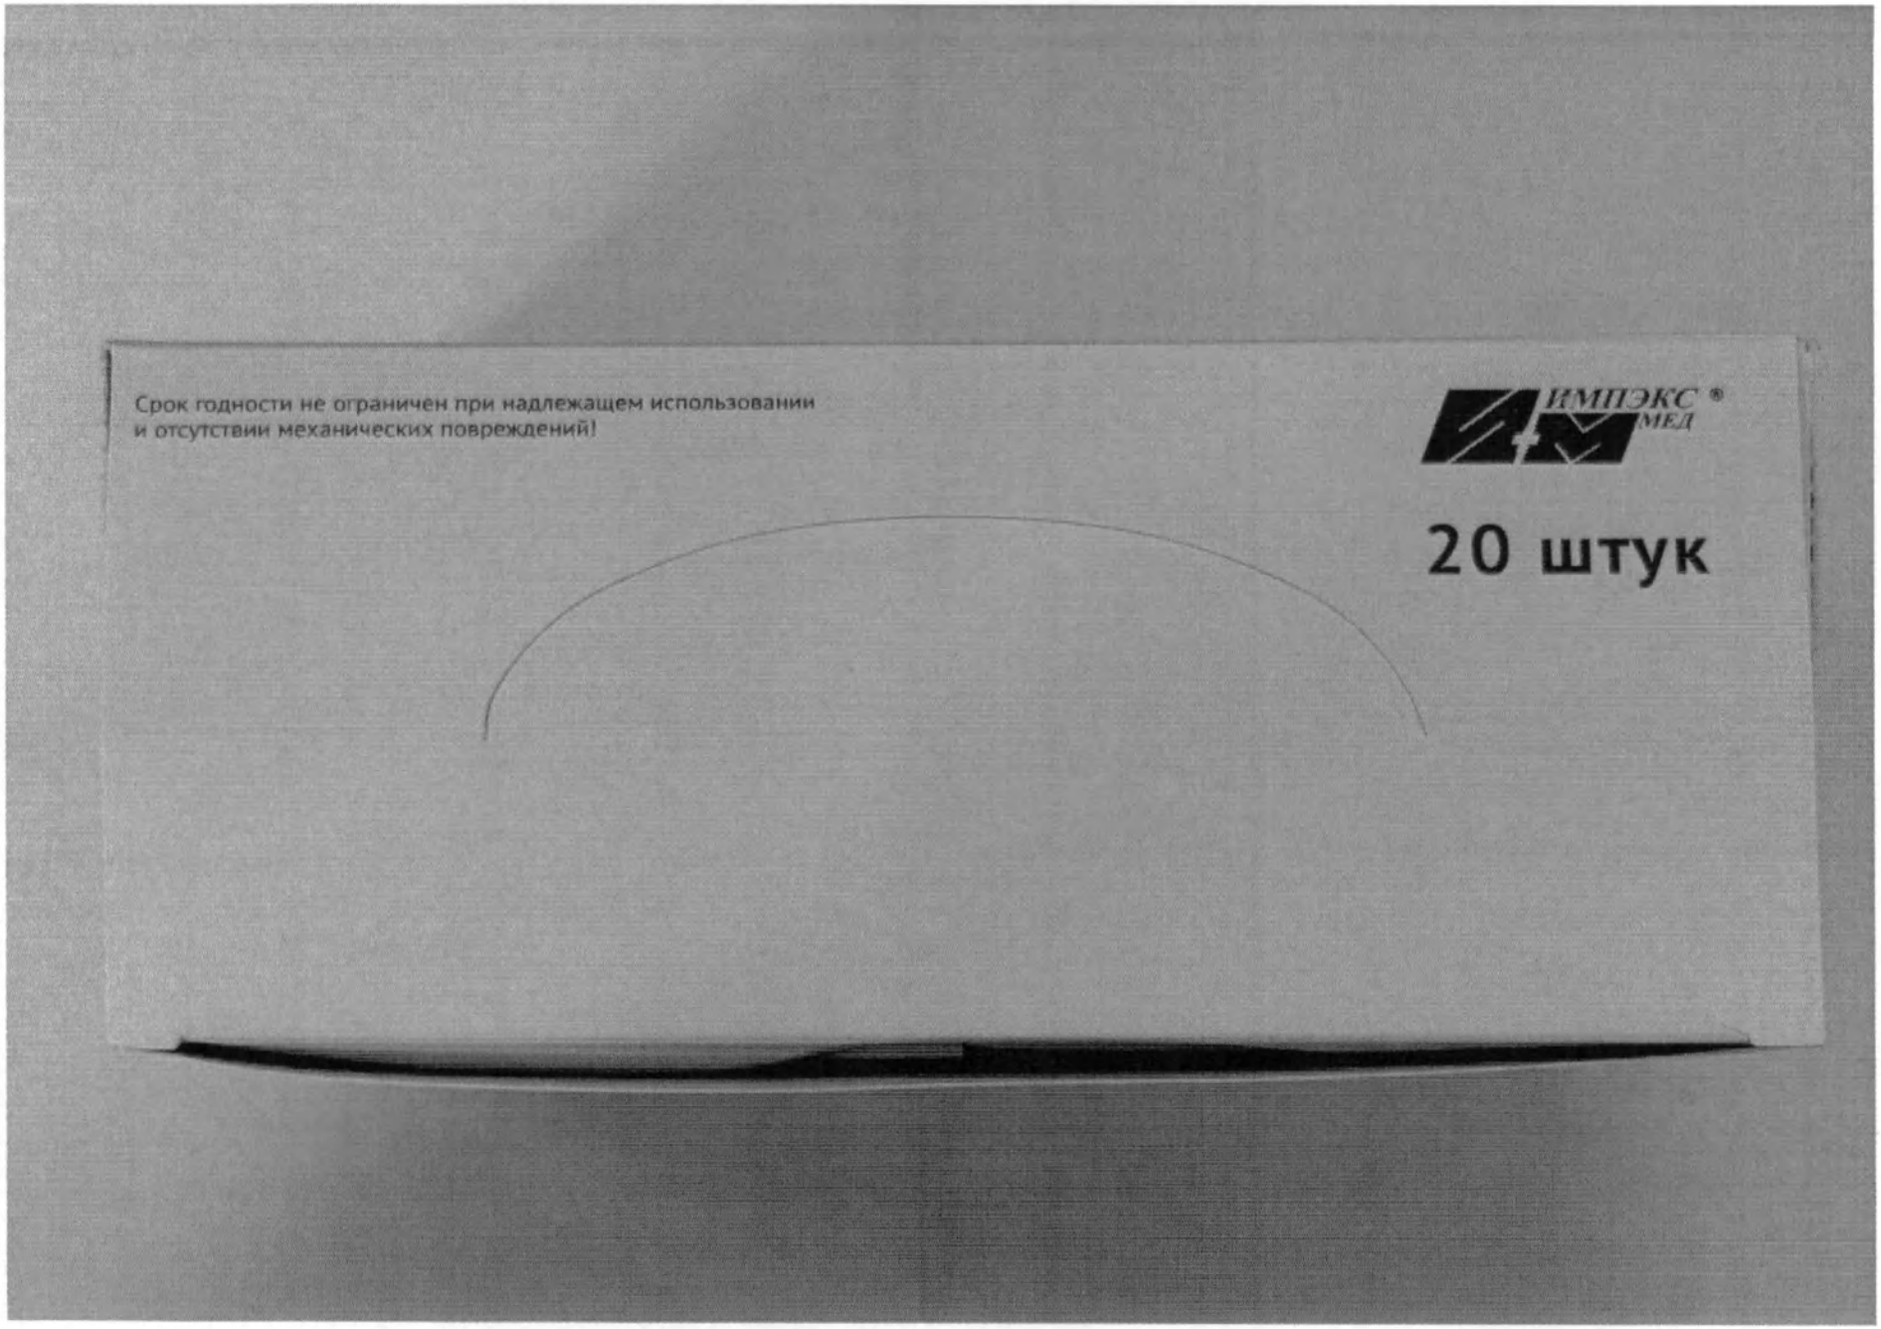

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

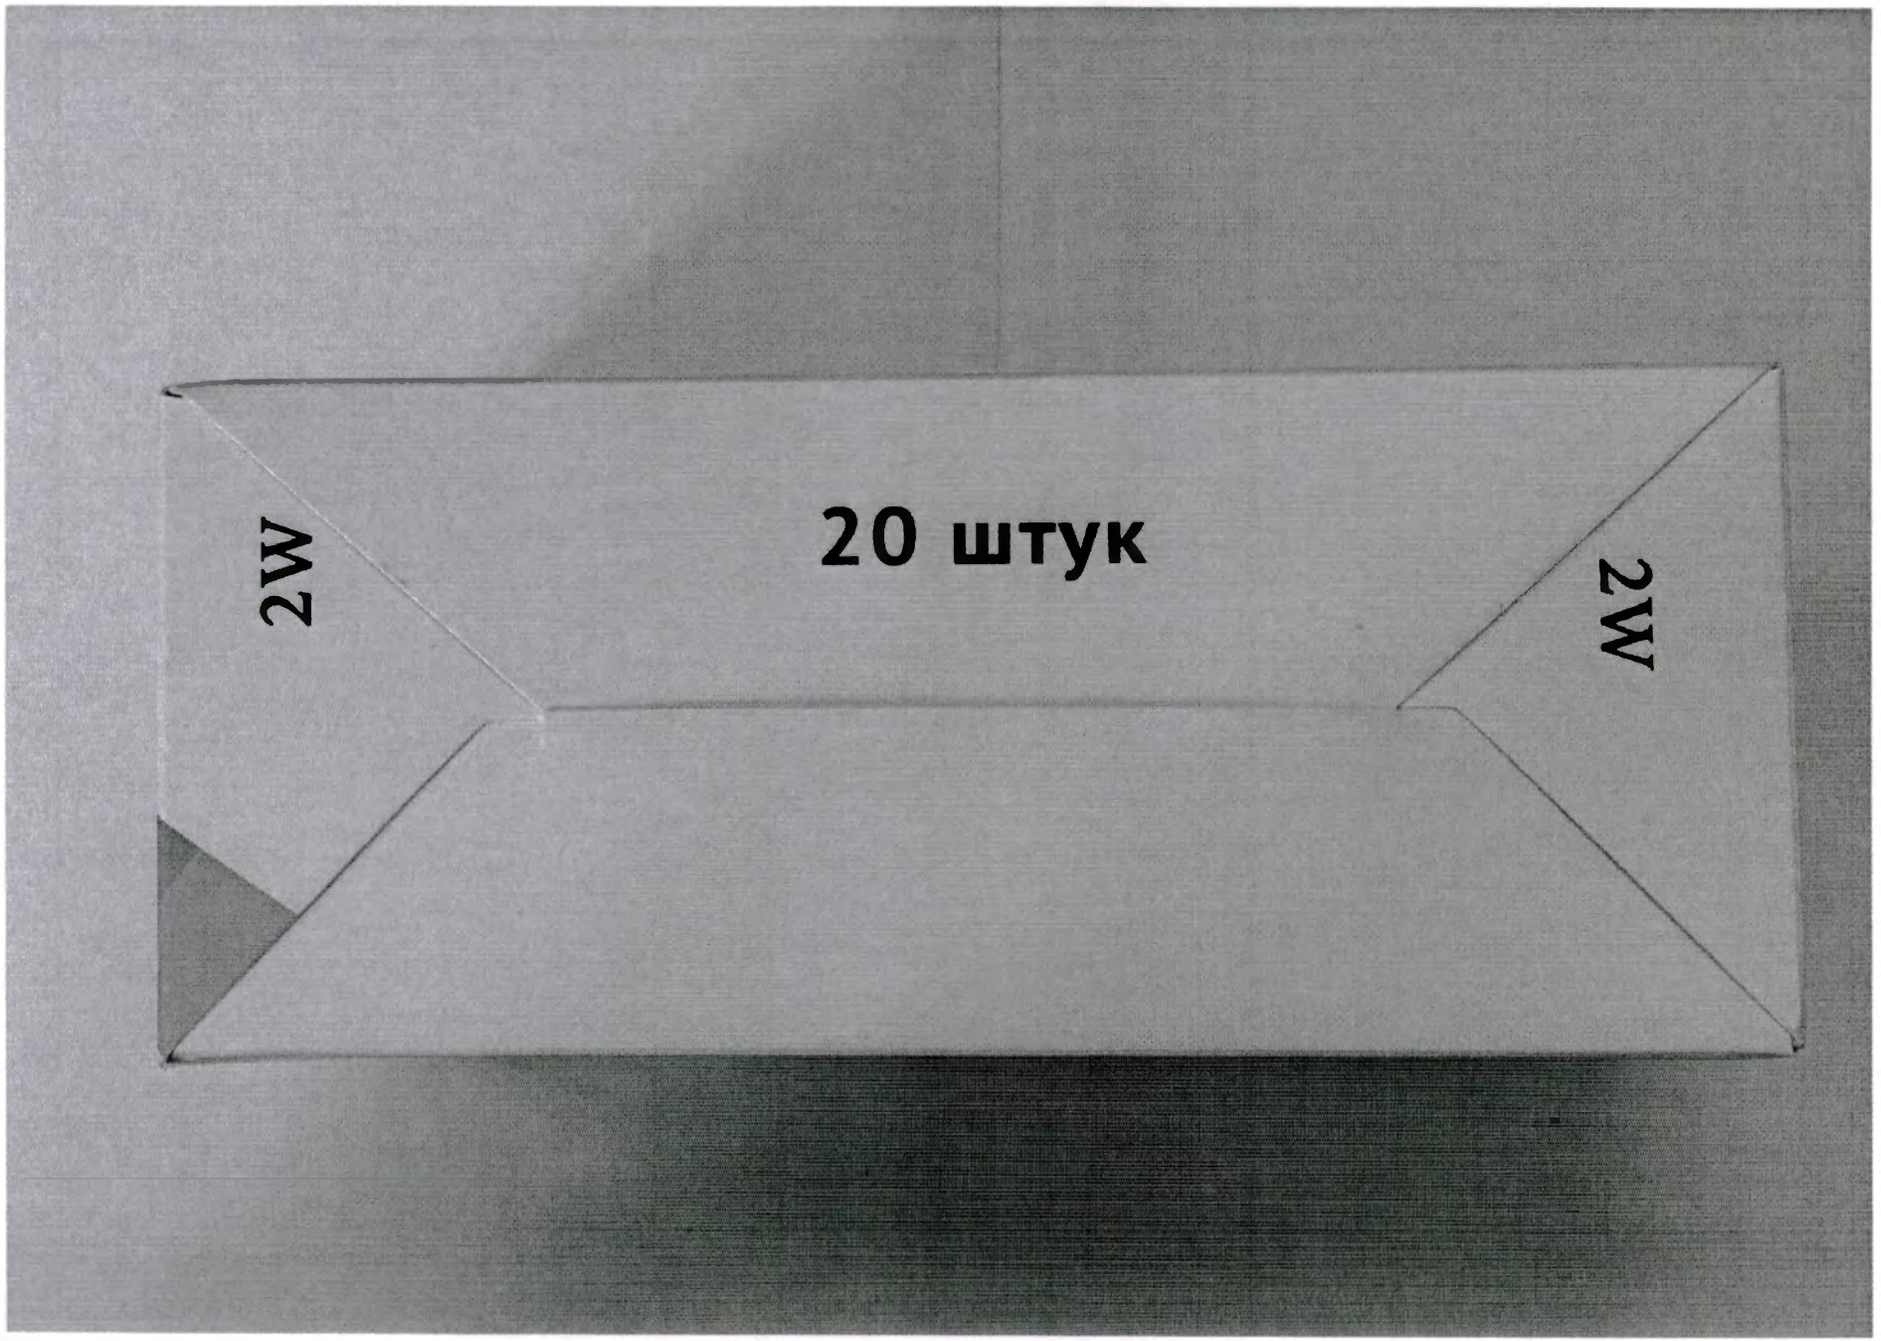

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 1W:

ИМПЭКС® МЕД

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный

Футляр классический. Инструкция по применению.

Произведено по заказу ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ,
127644, Москва, ул. Лобненская, д. 21, стр. 2.
Телефон/факс многоканальный +7(495) 921-30-58.
www.impex-med.ru; E-mail: moscow@impex-med.ru

БЕЗ РТУТИ

Производитель и место производства медицинского изделия: "Вукси Медикал Инструмент Фактори Ко., Лтд.", Китай, Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd., No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China.

CE 1023

Термометр соответсвует ГОСТ 31516-2012.
Зарегестрирован в РОССИИ.
Внесён в Гос. реестр средств измерений под № 48784-11. Поверен. Тип ТМБР

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный (Тип ТМБР)
в составе: 1. Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный.
2. Футляр классический. 3. Инструкция по применению.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572 от 28.12.2021 года. Бессрочно.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД

Thermometer medical maximum glass "IMPEX-MED"® mercury free

Classic case. Instruction for use.

MERCURY FREE

Транспортирование и хранение.

Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта.

Термометры следует транспортировать и хранить при температуре внешней среды от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты продажи.

⚠ Осторожно стекло!

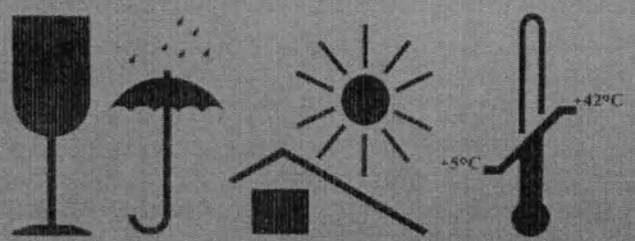

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный (Тип ТМБР) Футляр для легкого встряхивания.

- индивидуальная упаковка 4W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный "МИЗЖС-МЕД"® безртутный (Тип ТМБР) в составе:
1. Термометр медицинский максимальный стеклянный "МИЗЖС-МЕД"® безртутный. 2. Футляр для лёгкого встряхивания. 3. Инструкция по применению.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572 от 28.12.2021 года. Бессрочно.

Термометр медицинский максимальный стеклянный "МИЗЖС-МЕД"® безртутный.
футляр для лёгкого встряхивания. Инструкция по применению.

1 ШТУКА

Транспортировка и хранение. Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировке термометров упакованных в картонные пачки или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре воздуха от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. **Осторожно стекло!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производство по заказу ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ, 127644, Москва, ул. Лобненская, д. 21, стр. 2. Телефон +7(495) 921-30-58, www.impex-med.ru; E-mail: mosow@impex-med.ru Производитель и место производства медицинского изделия: "Вуси Медикал Инструмент Фэктори Со., Лтд", No. 43 Xishi Road, Zhangjiagang, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China. Гермометр инсекин в Тес. реестр средств измерений № 48781-11. Тип ГМБР.

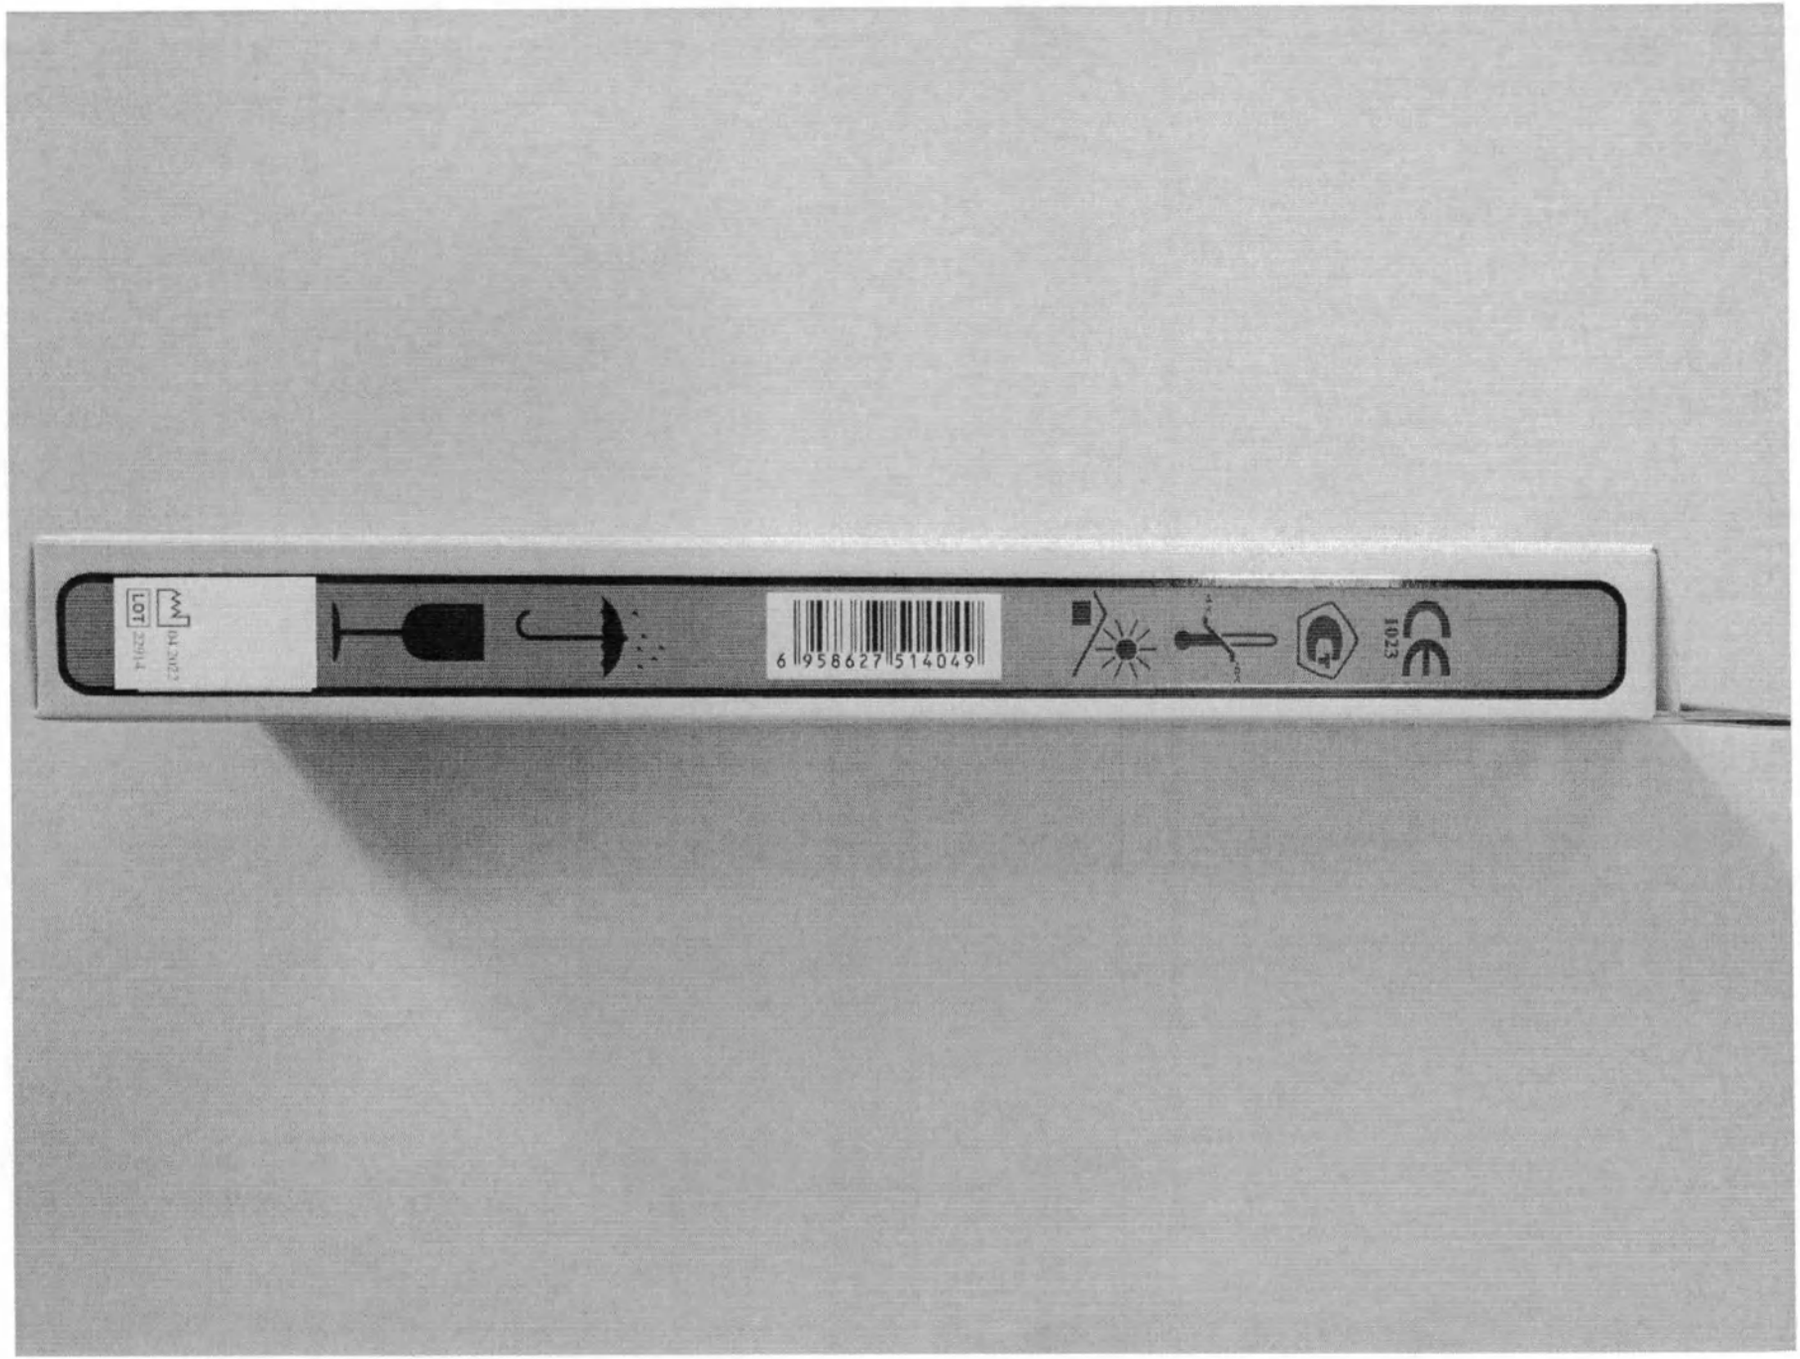

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

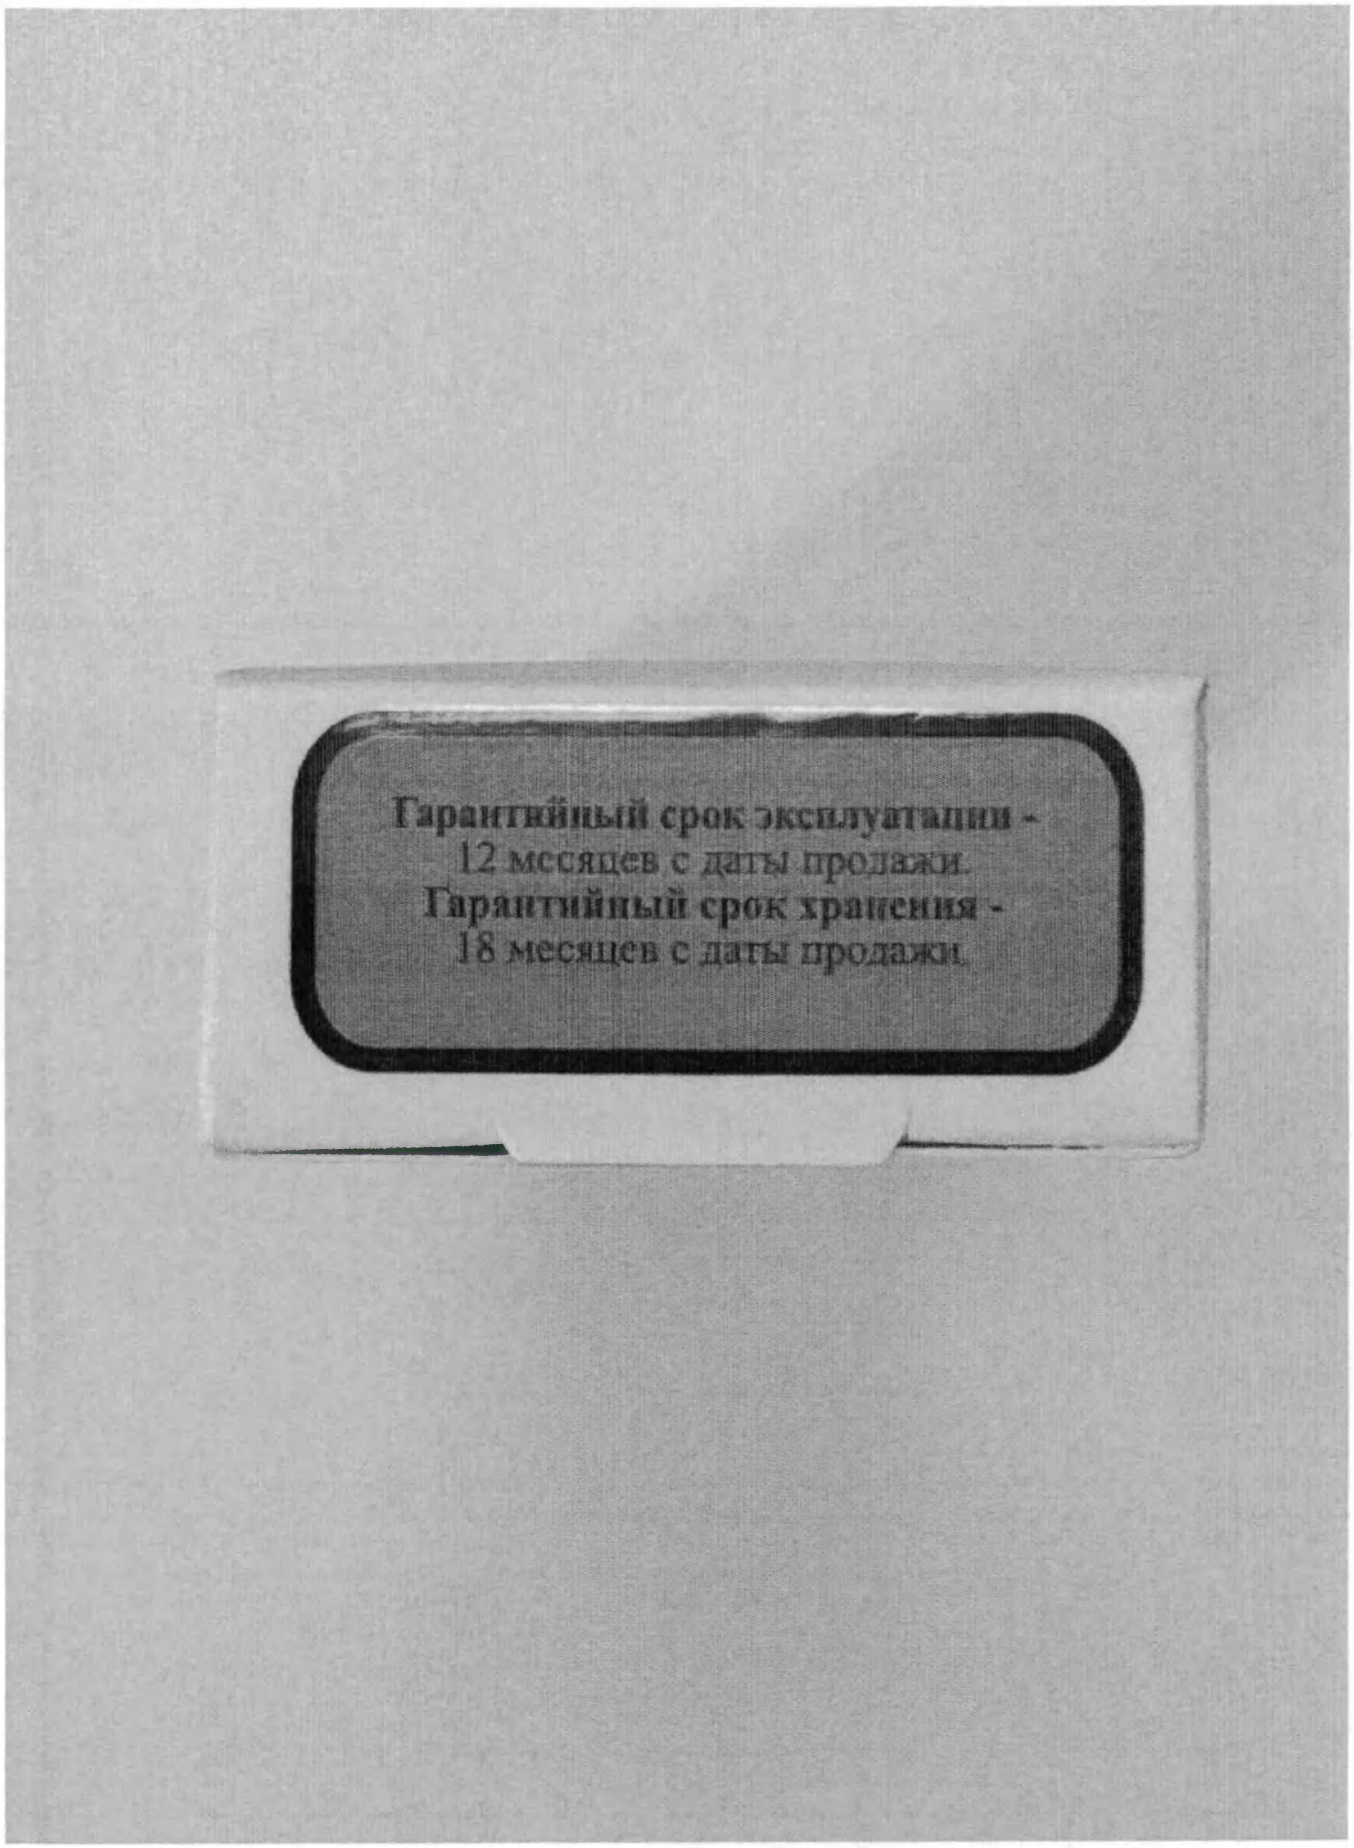

- групповая упаковка 4W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"® безртутный (Тип ТМБР)
в составе: 1. Термометр медицинский максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"® безртутный. 2. Футляр для лёгкого встряхивания.
3. Инструкция по применению.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572
от 28.12.2021 года. Бессрочно.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД®

6 958627 514049

04.2022

LOT 22914

ТЕРМОМЕТР БЕЗ РТУТИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД®

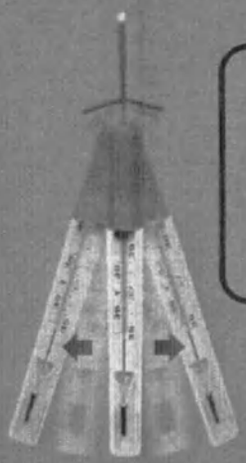

Thermometer medical maximum glass "IMPEX-MED"® mercury free

Case for easy shaking.

Instruction for use.

MERCURY FREE

Транспортирование и хранение.
Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении.
При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики изгофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре внешней среды от +5°С до +42°С.
Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты продажи.

⚠ **Осторожно стекло!**

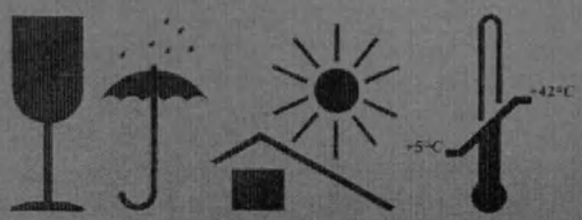

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный (Тип ТМБР) Футляр-лупа.

- индивидуальная упаковка 3W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

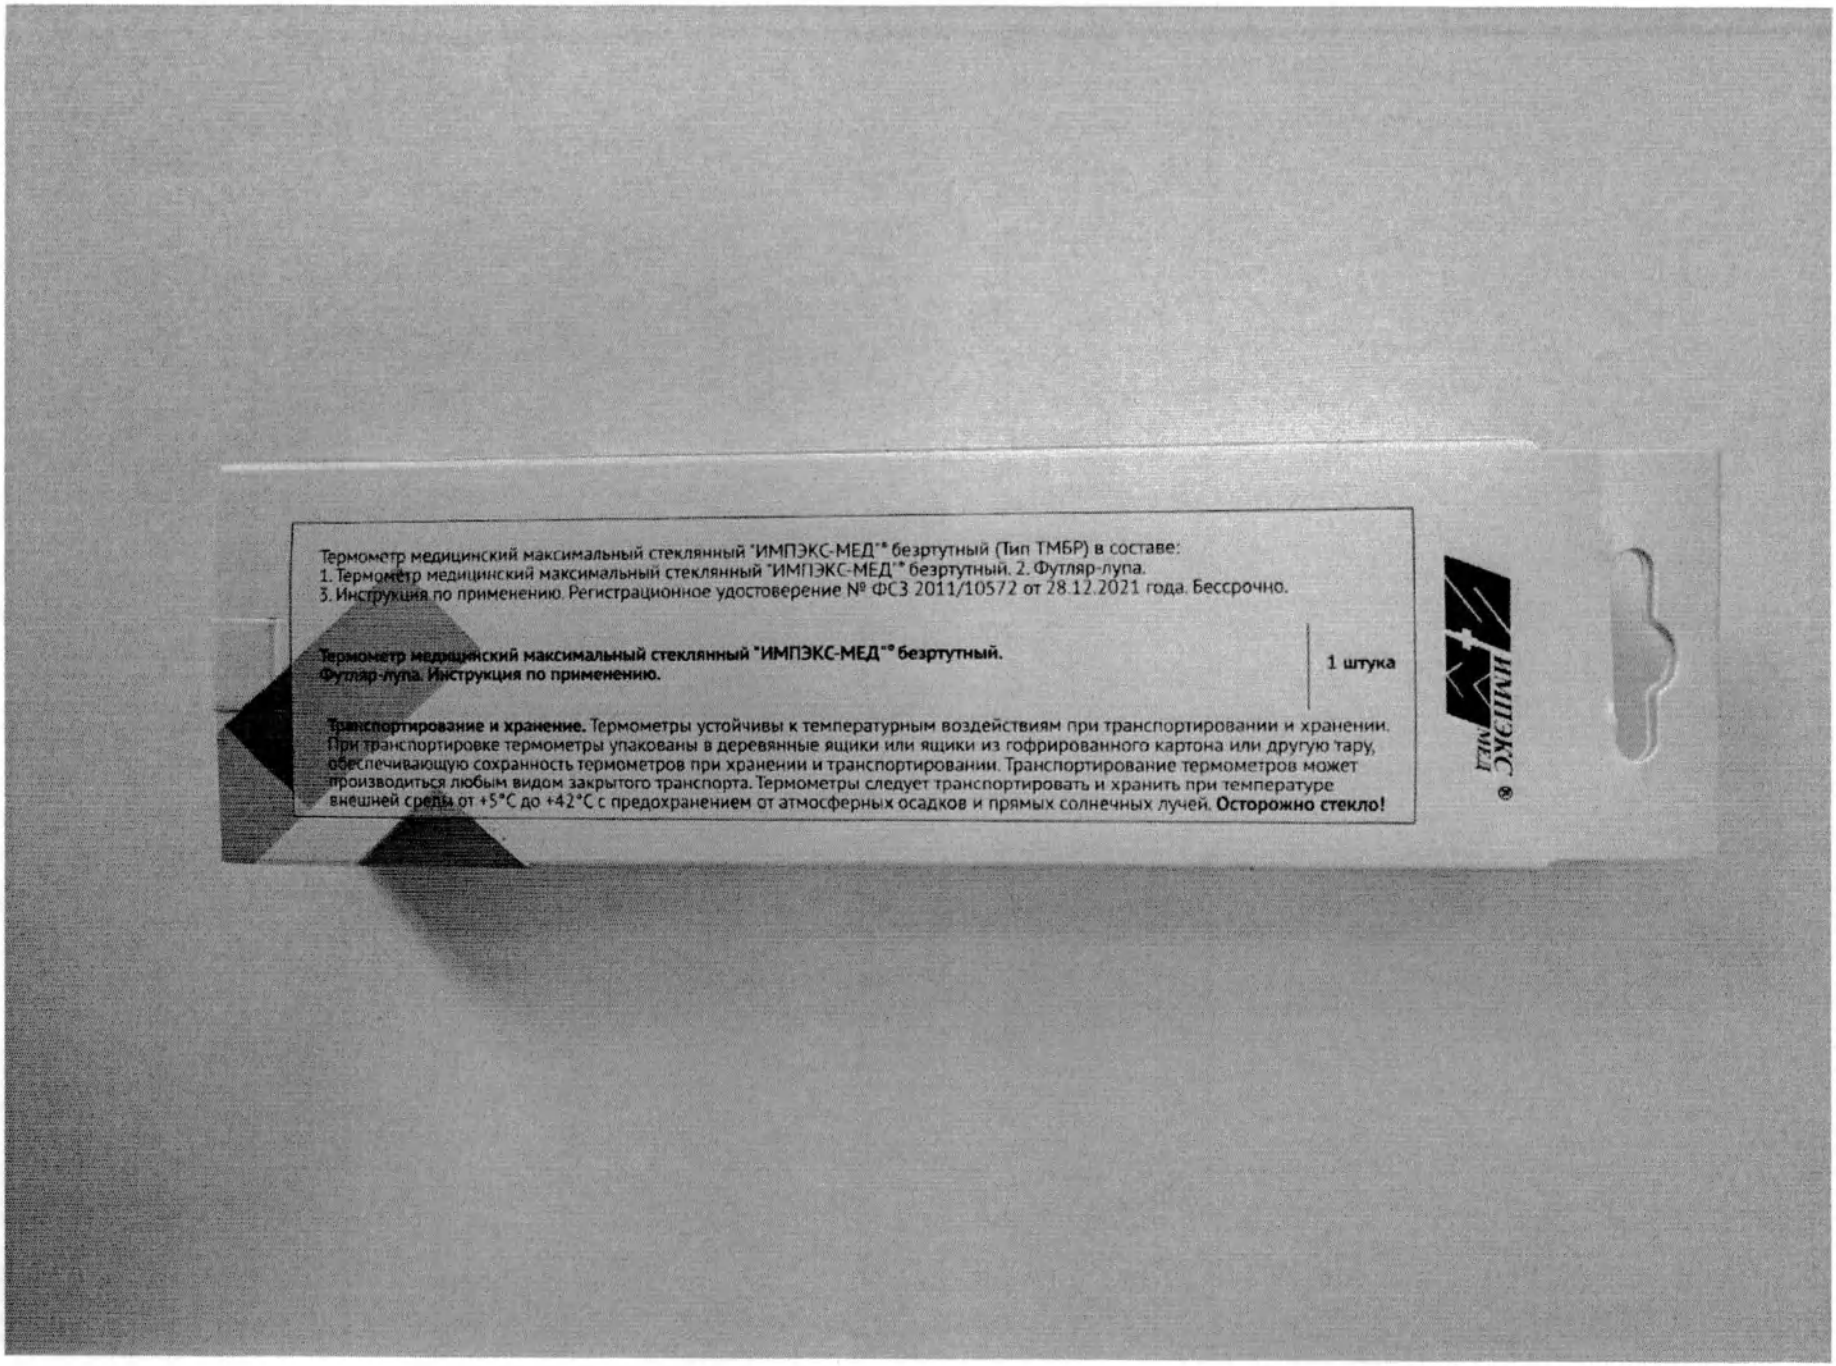

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

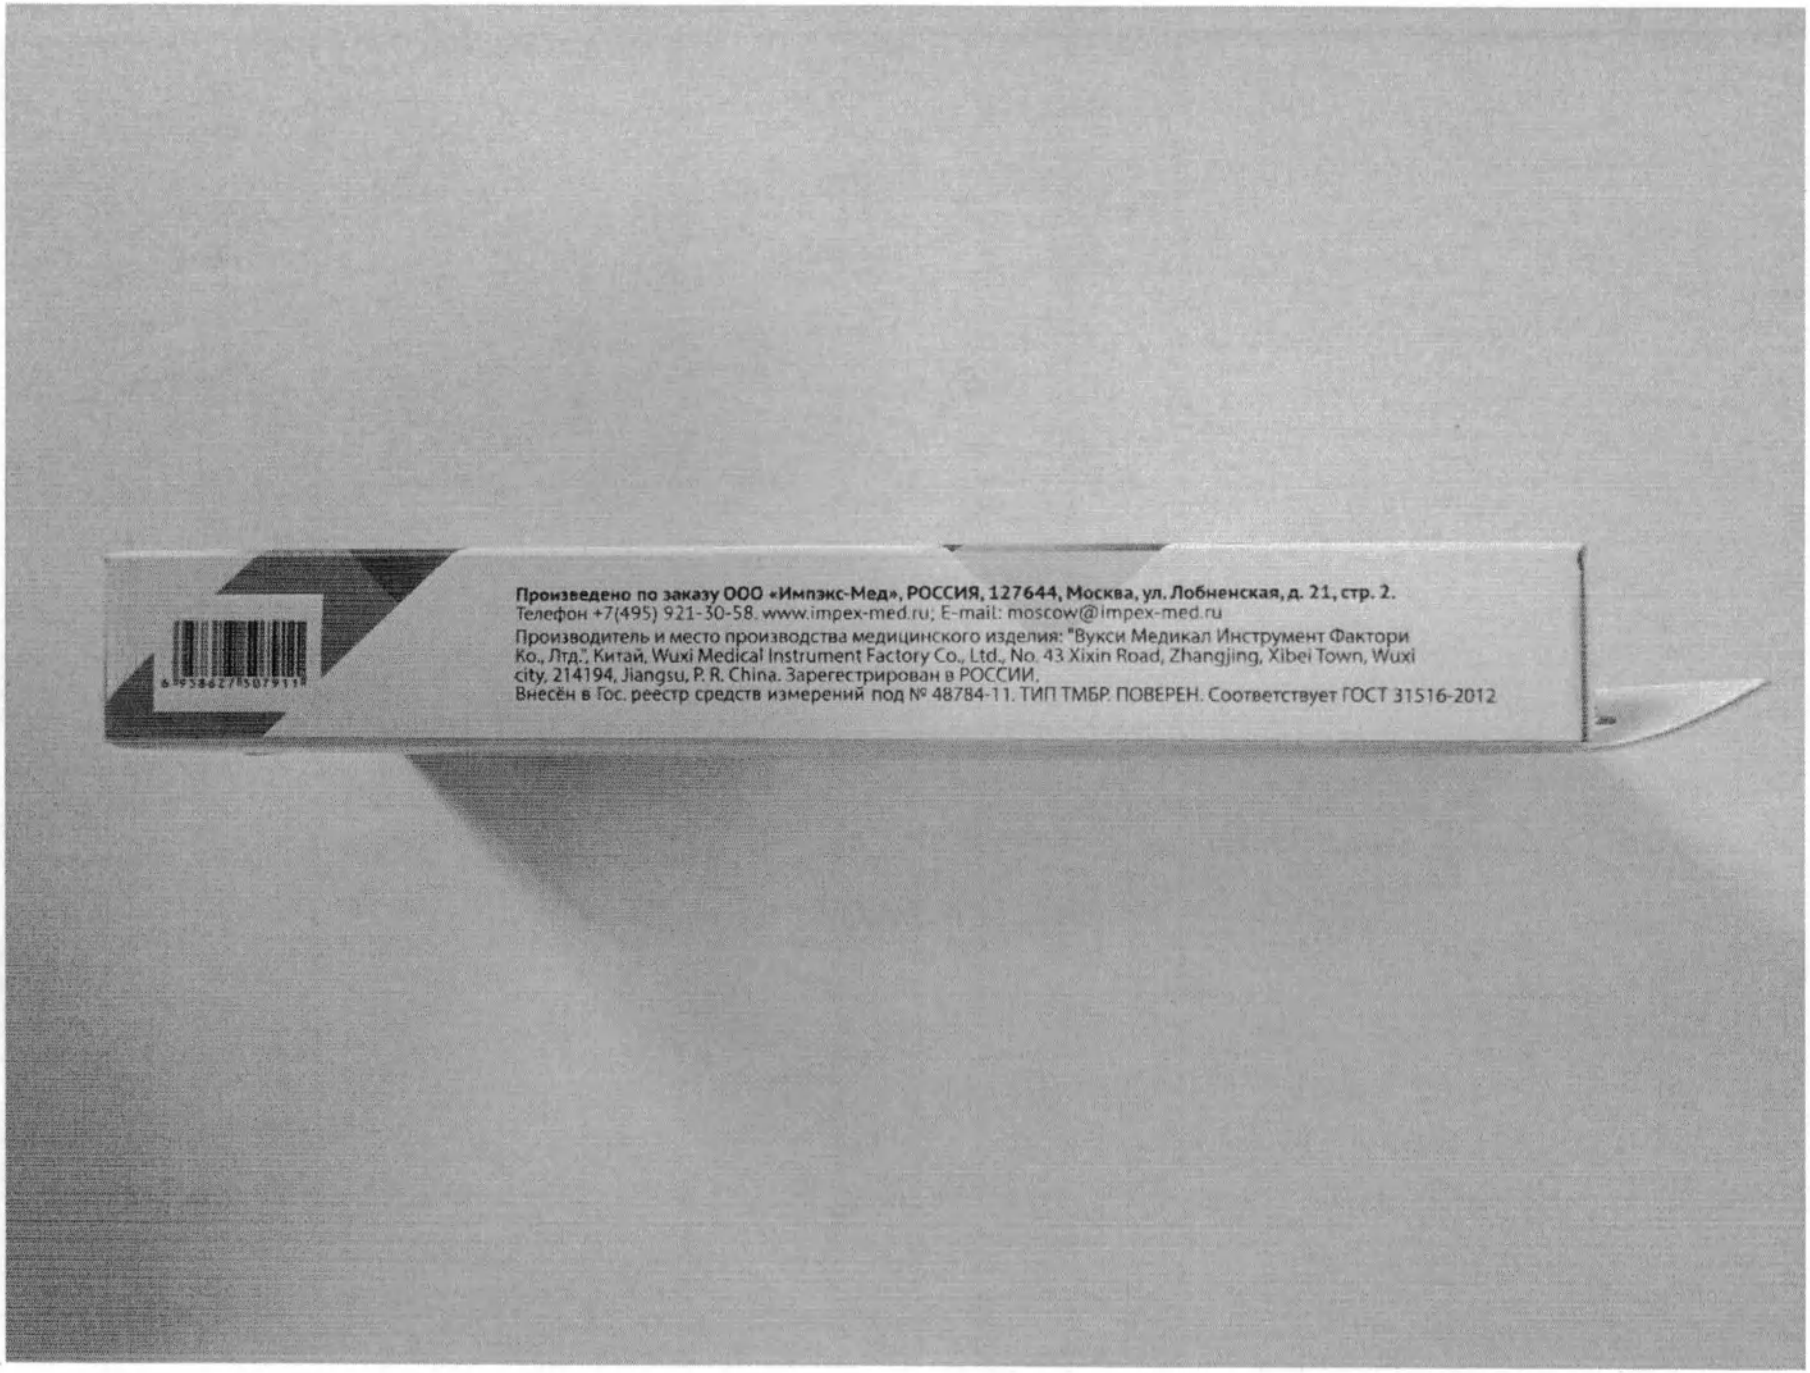

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

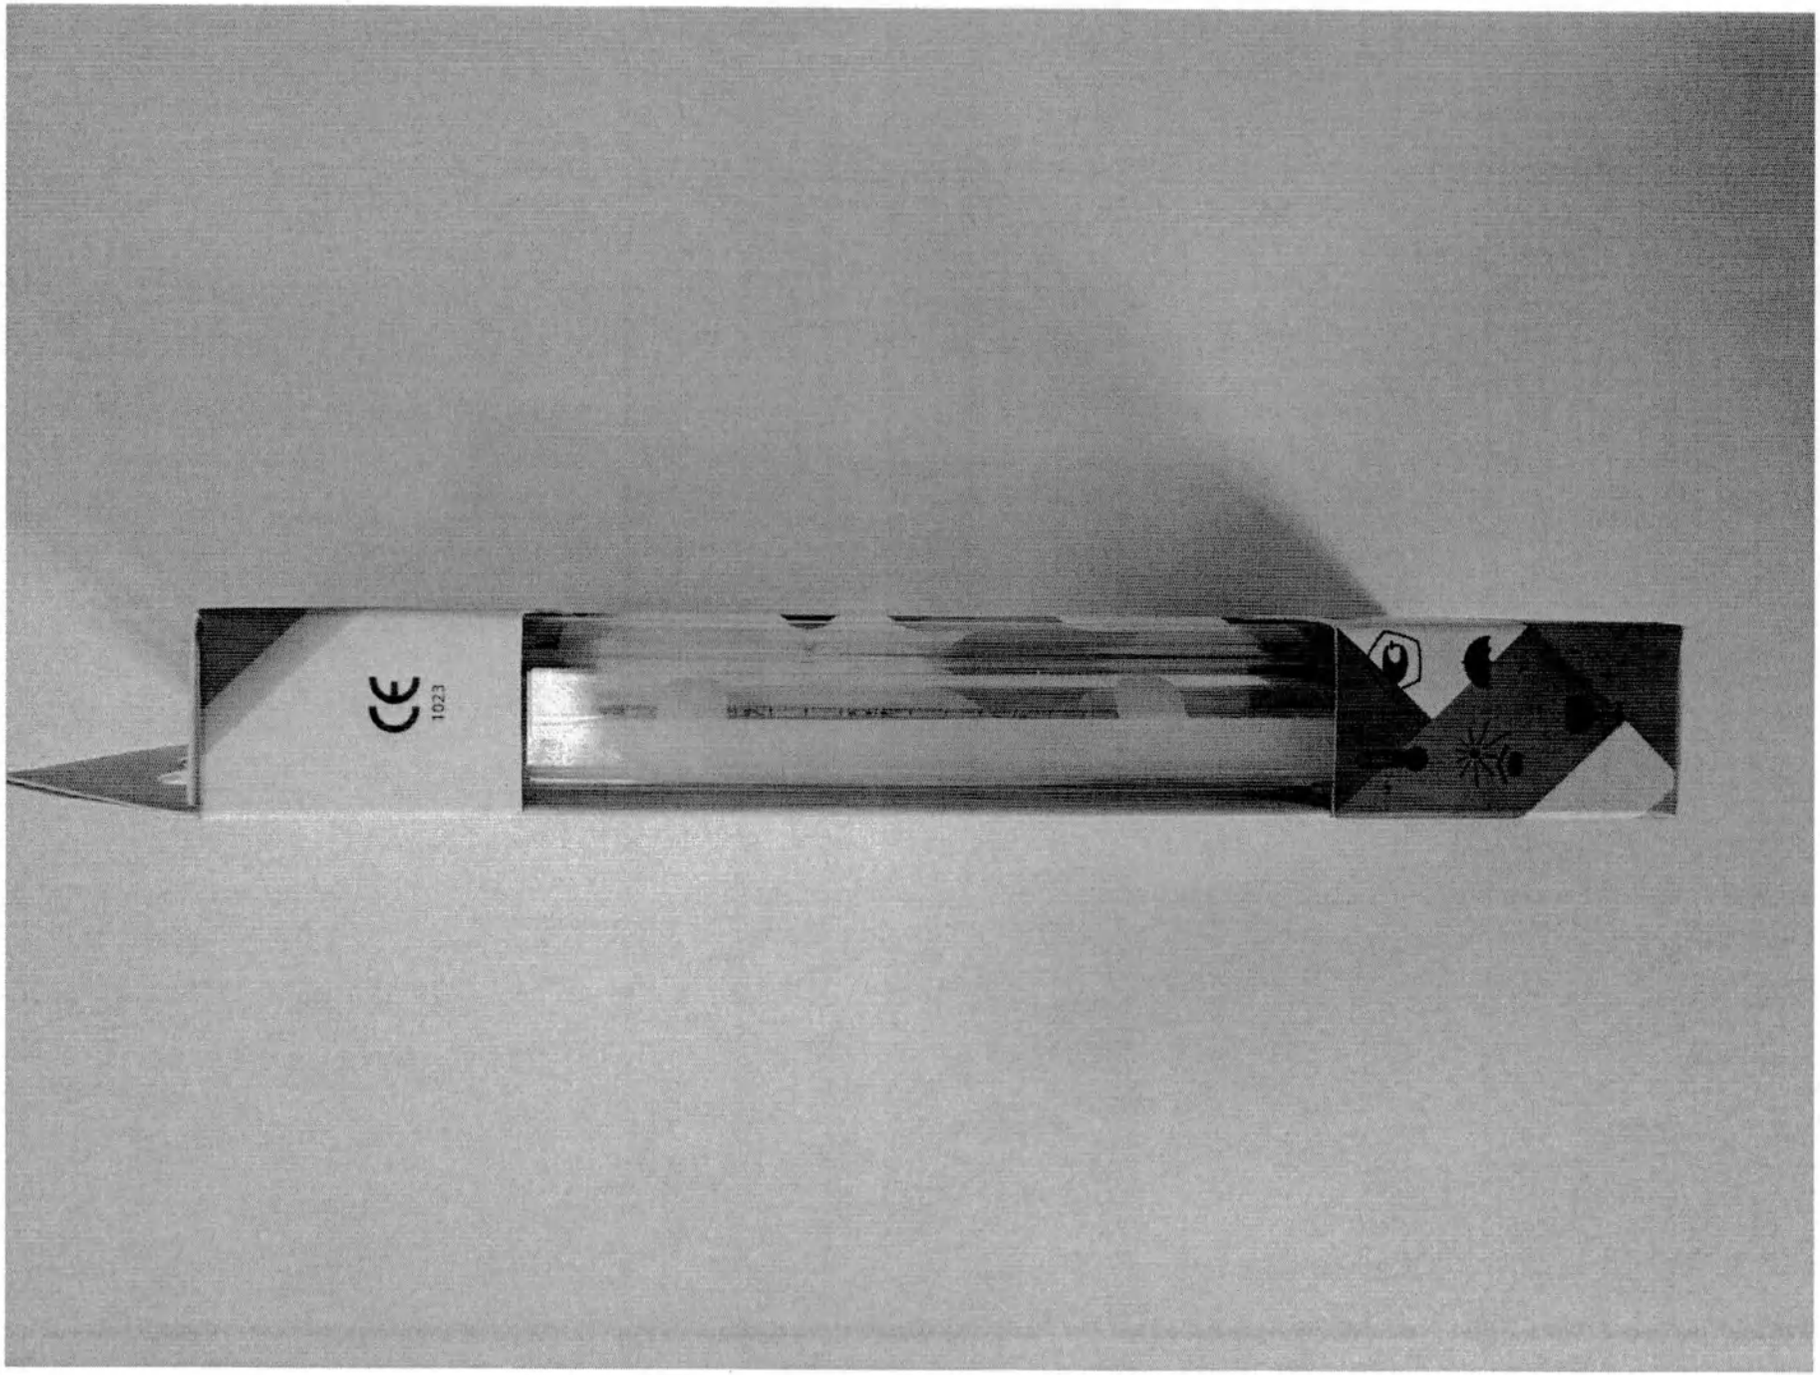

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

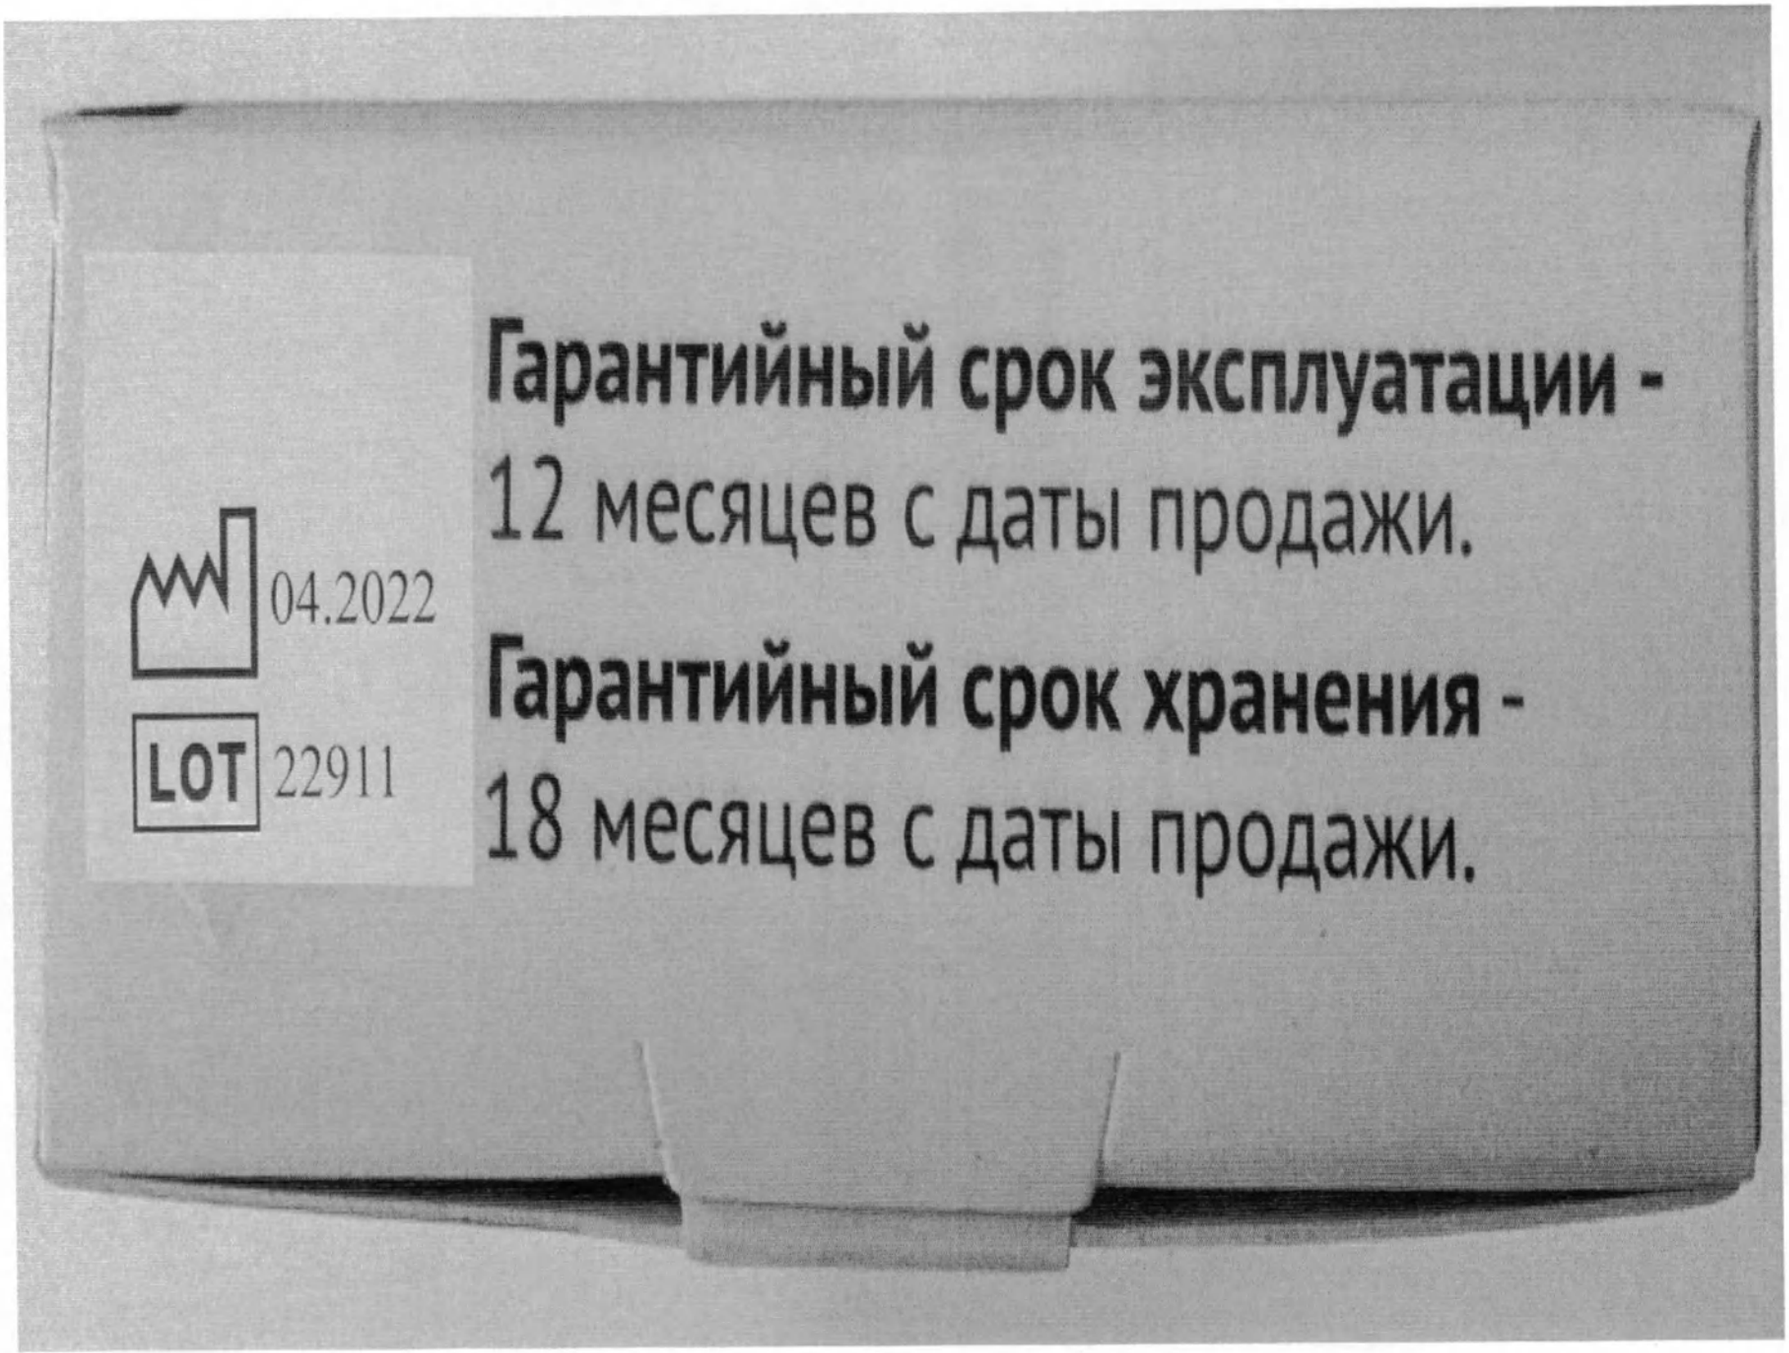

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 3W:

ИМПЭКС МЕД®

6 958627 507911

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"®
безртутный

Футляр-лупа.
Инструкция по применению.

Thermometer medical
maximum glass
"IMPEX-MED"®
mercury free

Magnifying case.
Instruction for use.

Производитель и место производства медицинского изделия: "Вукси Медикал Инструмент Фактори Ко., Лтд.", Китай, Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd., No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China.

Транспортирование и хранение.
Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении.
При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании.
Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре внешней среды от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

⚠ **Осторожно стекло!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

Срок годности не ограничен при надлежащем использовании и отсутствии механических повреждений

Зарегистрирован в РОССИИ
Внесён в Гос. реестр средств измерений
под № 48784-11. ПОВЕРЕН. ТИП ТМБР

Термометр соответсвует ГОСТ 31516-2012

Индивидуальная упаковка

БЕЗ РТУТИ

ФУТЛЯР - ЛУПА

Произведено по заказу
ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ,
127644, Москва, ул. Лобненская,
д. 21, стр. 2.
Телефон +7(495) 921-30-58.
www.impex-med.ru;
E-mail: moscow@impex-med.ru

CE 1023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД ®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

БЕЗ РТУТИ

ФУТЛЯР - ЛУПА

Гарантийный срок эксплуатации -
12 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок хранения -
18 месяцев с даты продажи.

04.2022

LOT 22911

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

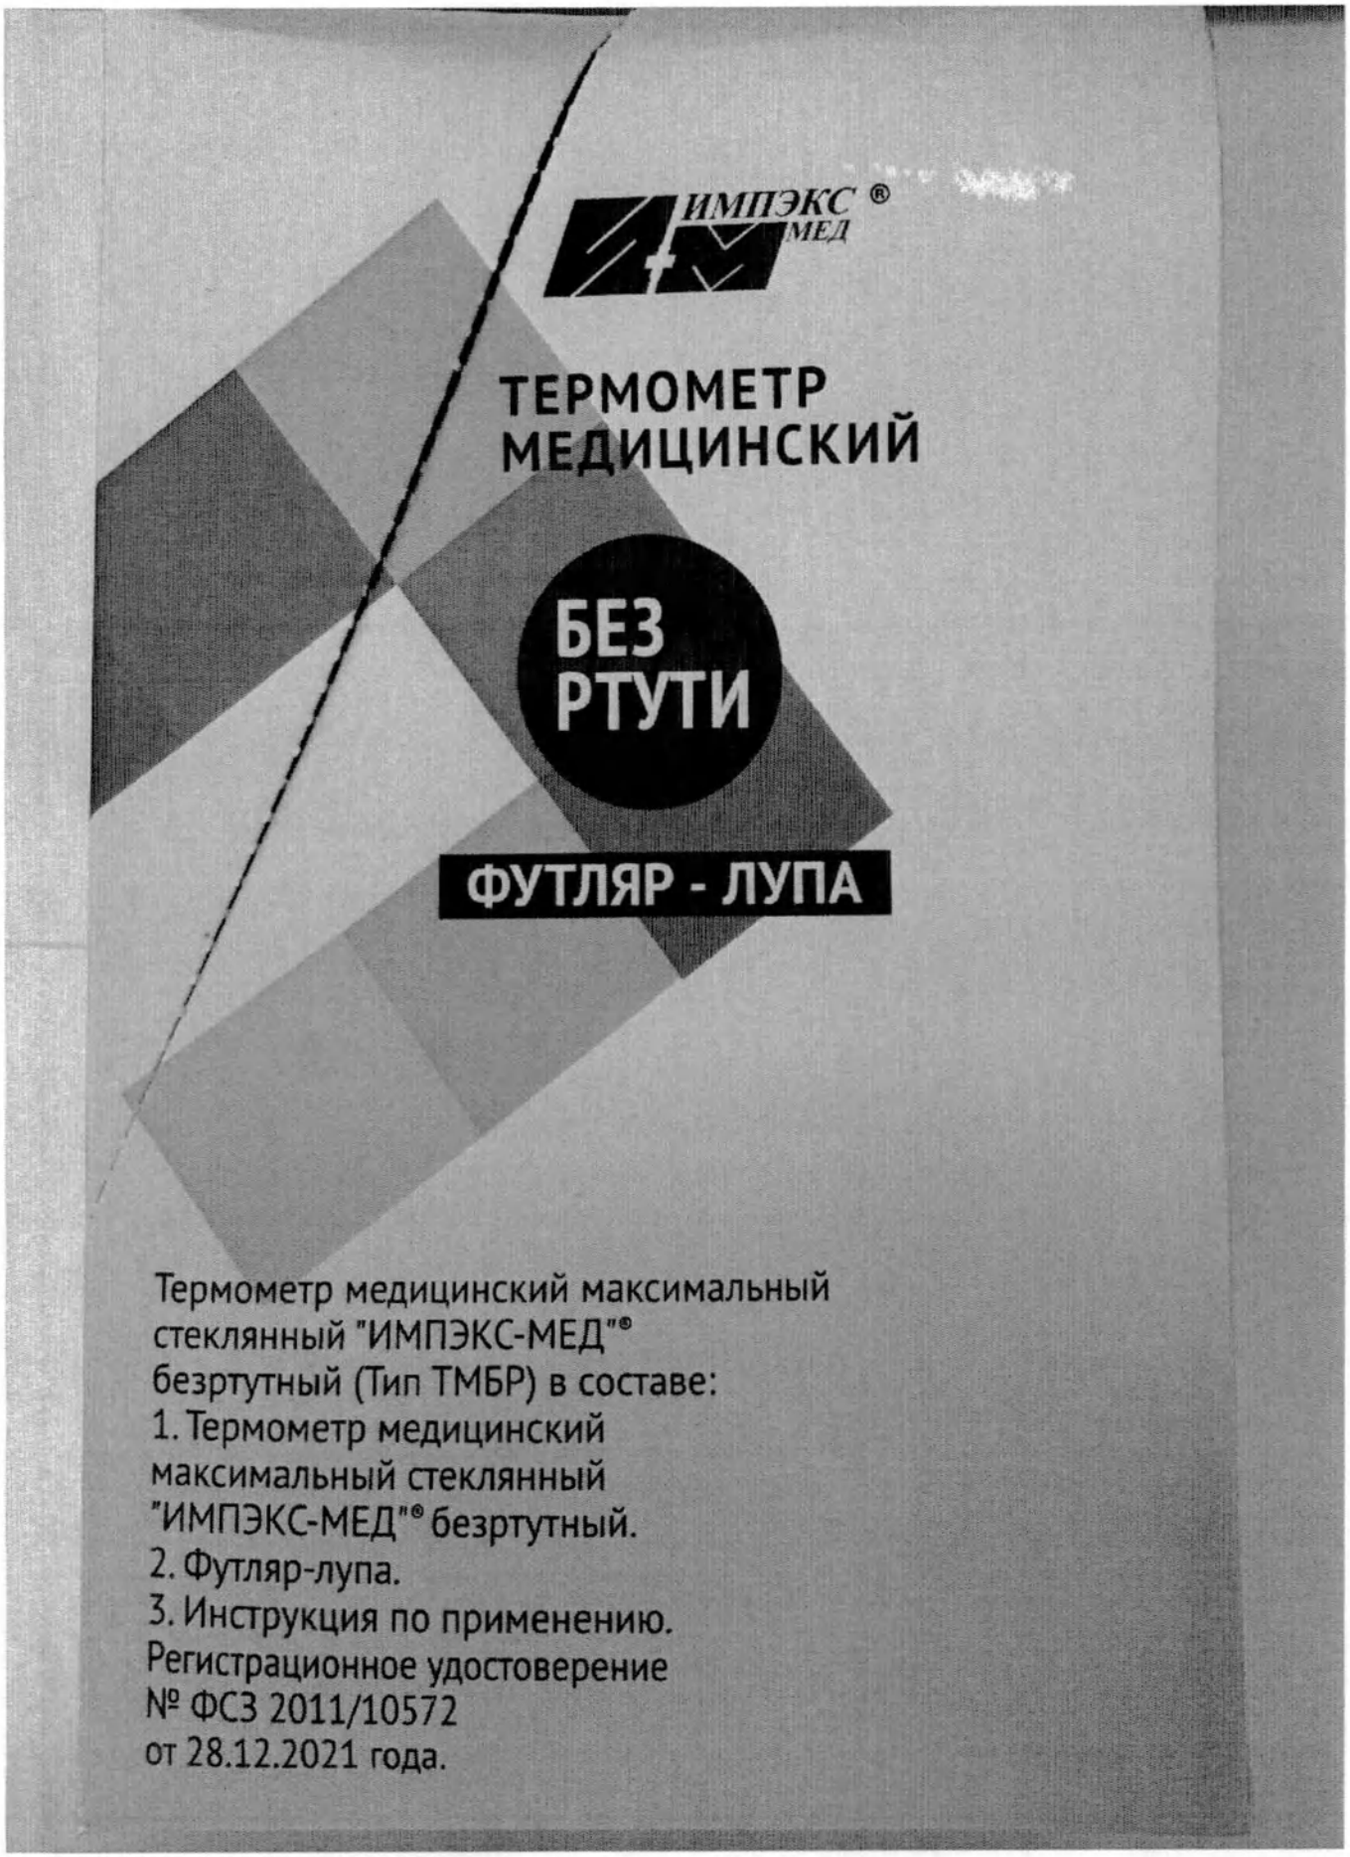

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный (Тип ТМБР) Футляр-люкс.

- индивидуальная упаковка 5W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

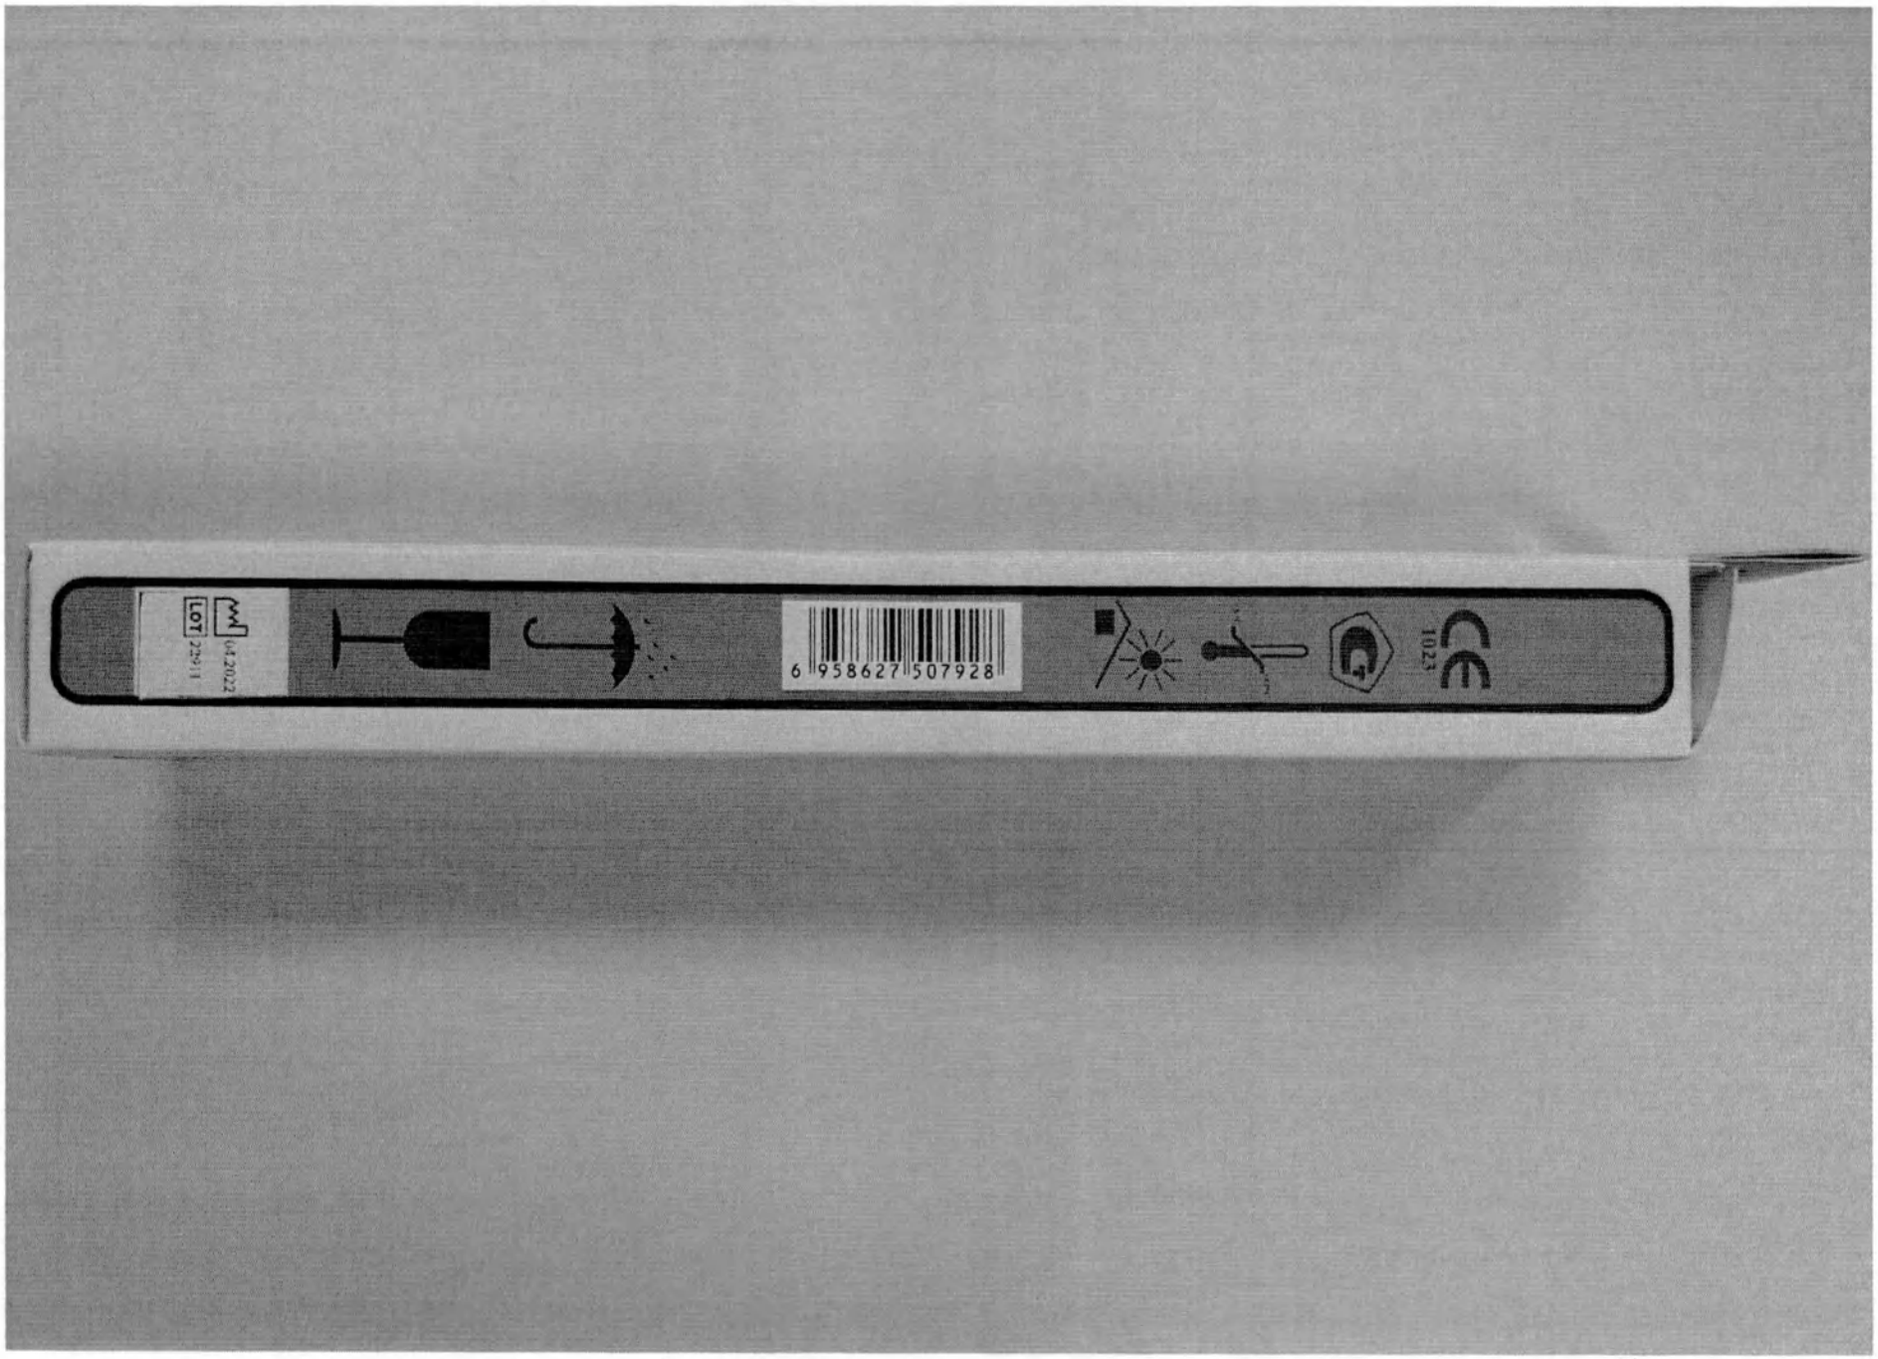

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

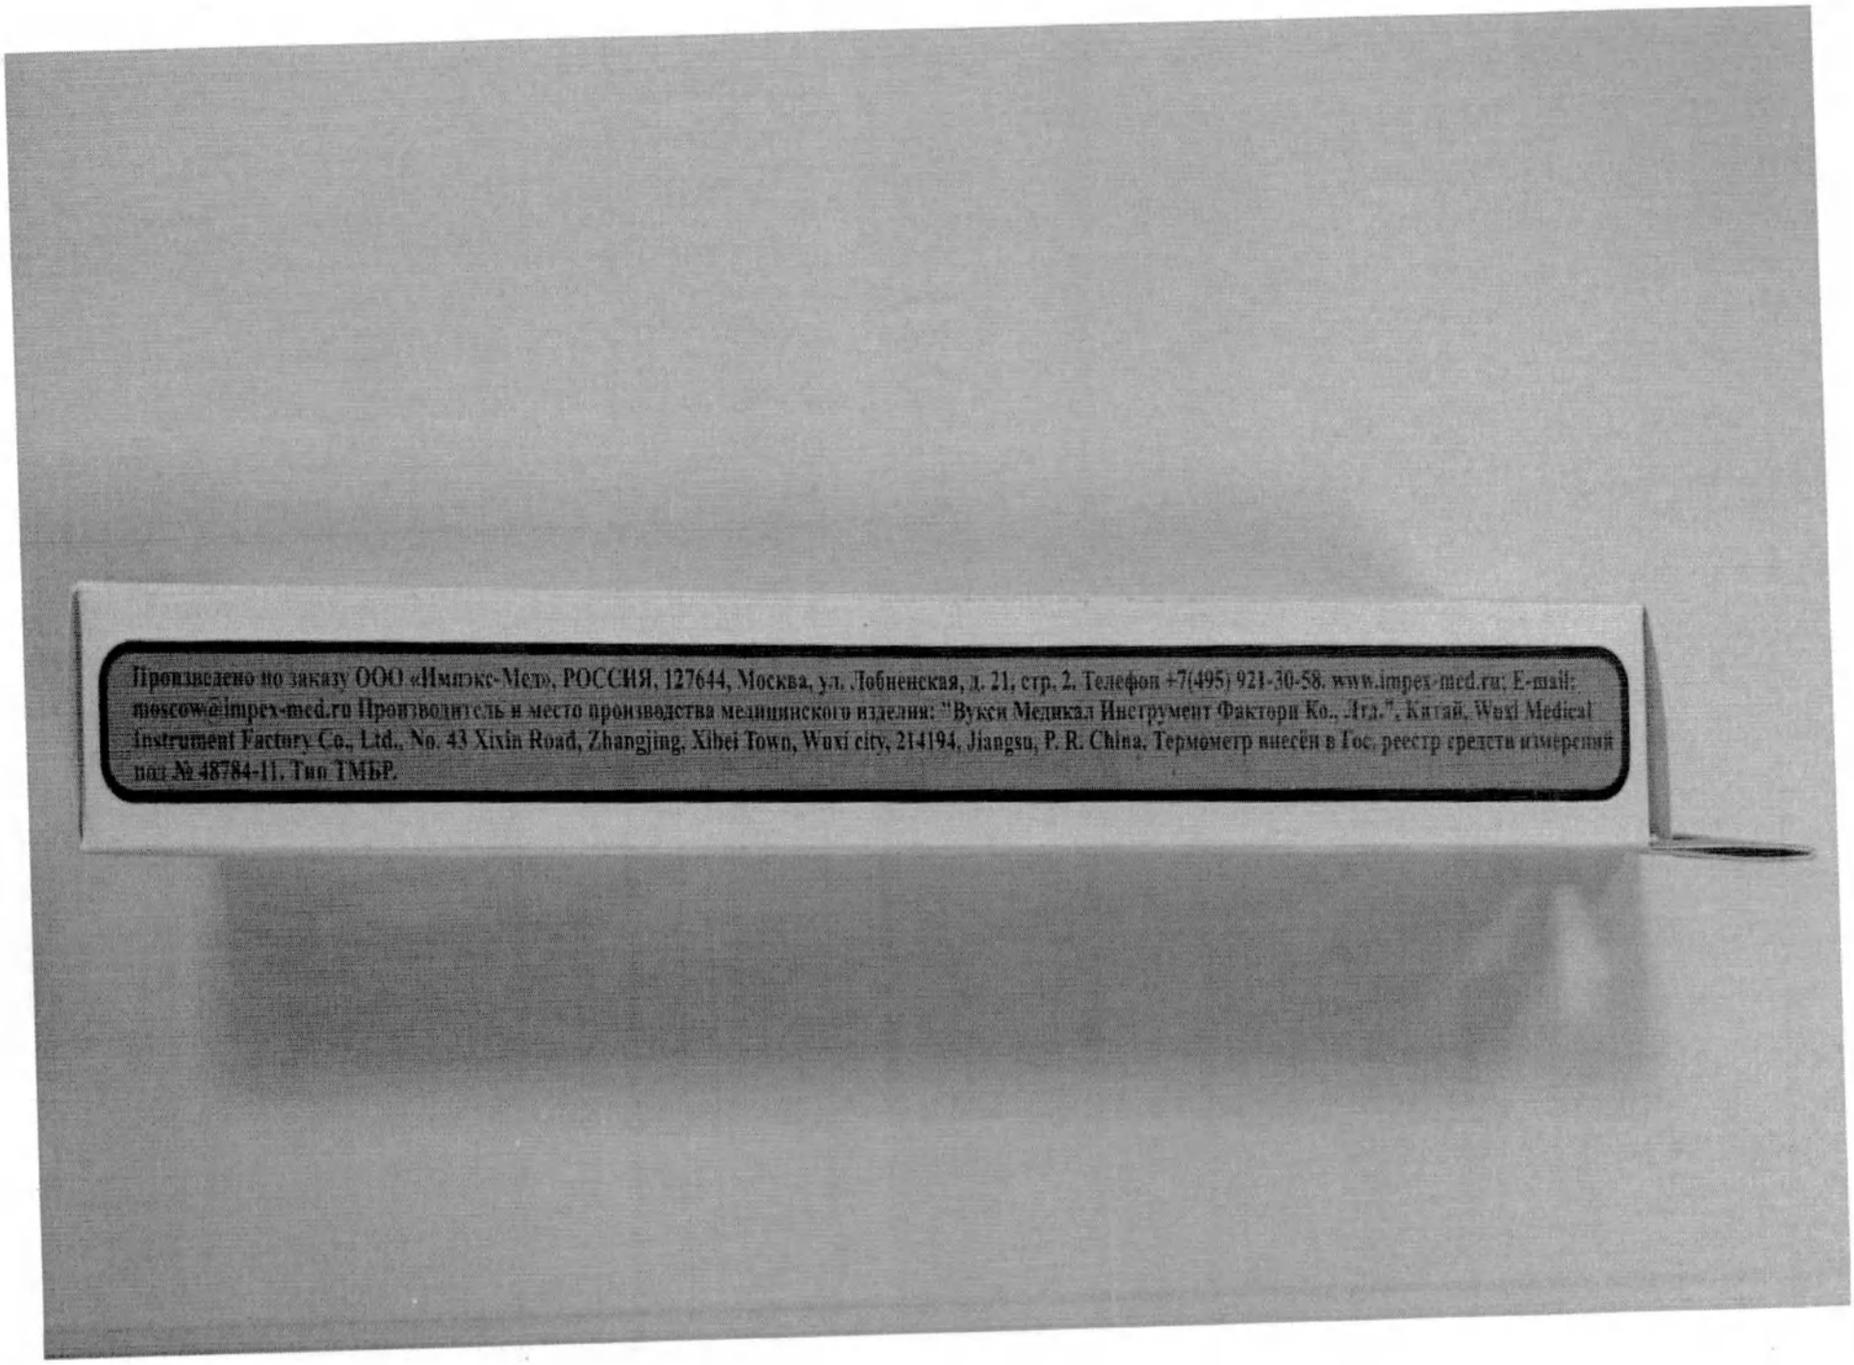

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

НОВИНКА

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМЗКС-МЕД"® безртутный (Тип ТМБР) в составе:
1. Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМЗКС-МЕД"® безртутный. 2. Футляр-люкс. 3. Инструкция по применению.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572 от 28.12.2021 года. Бессрочно.

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМЗКС-МЕД"® безртутный.
Футляр-люкс. Инструкция по применению.

1 ШТУКА

Транспортирование и хранение. Термометр устойчив к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упаковали в картонные коробки с перегородками, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании.
Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре воздуха от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков в пределах солнечных лучей. **Осторожно стекло!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

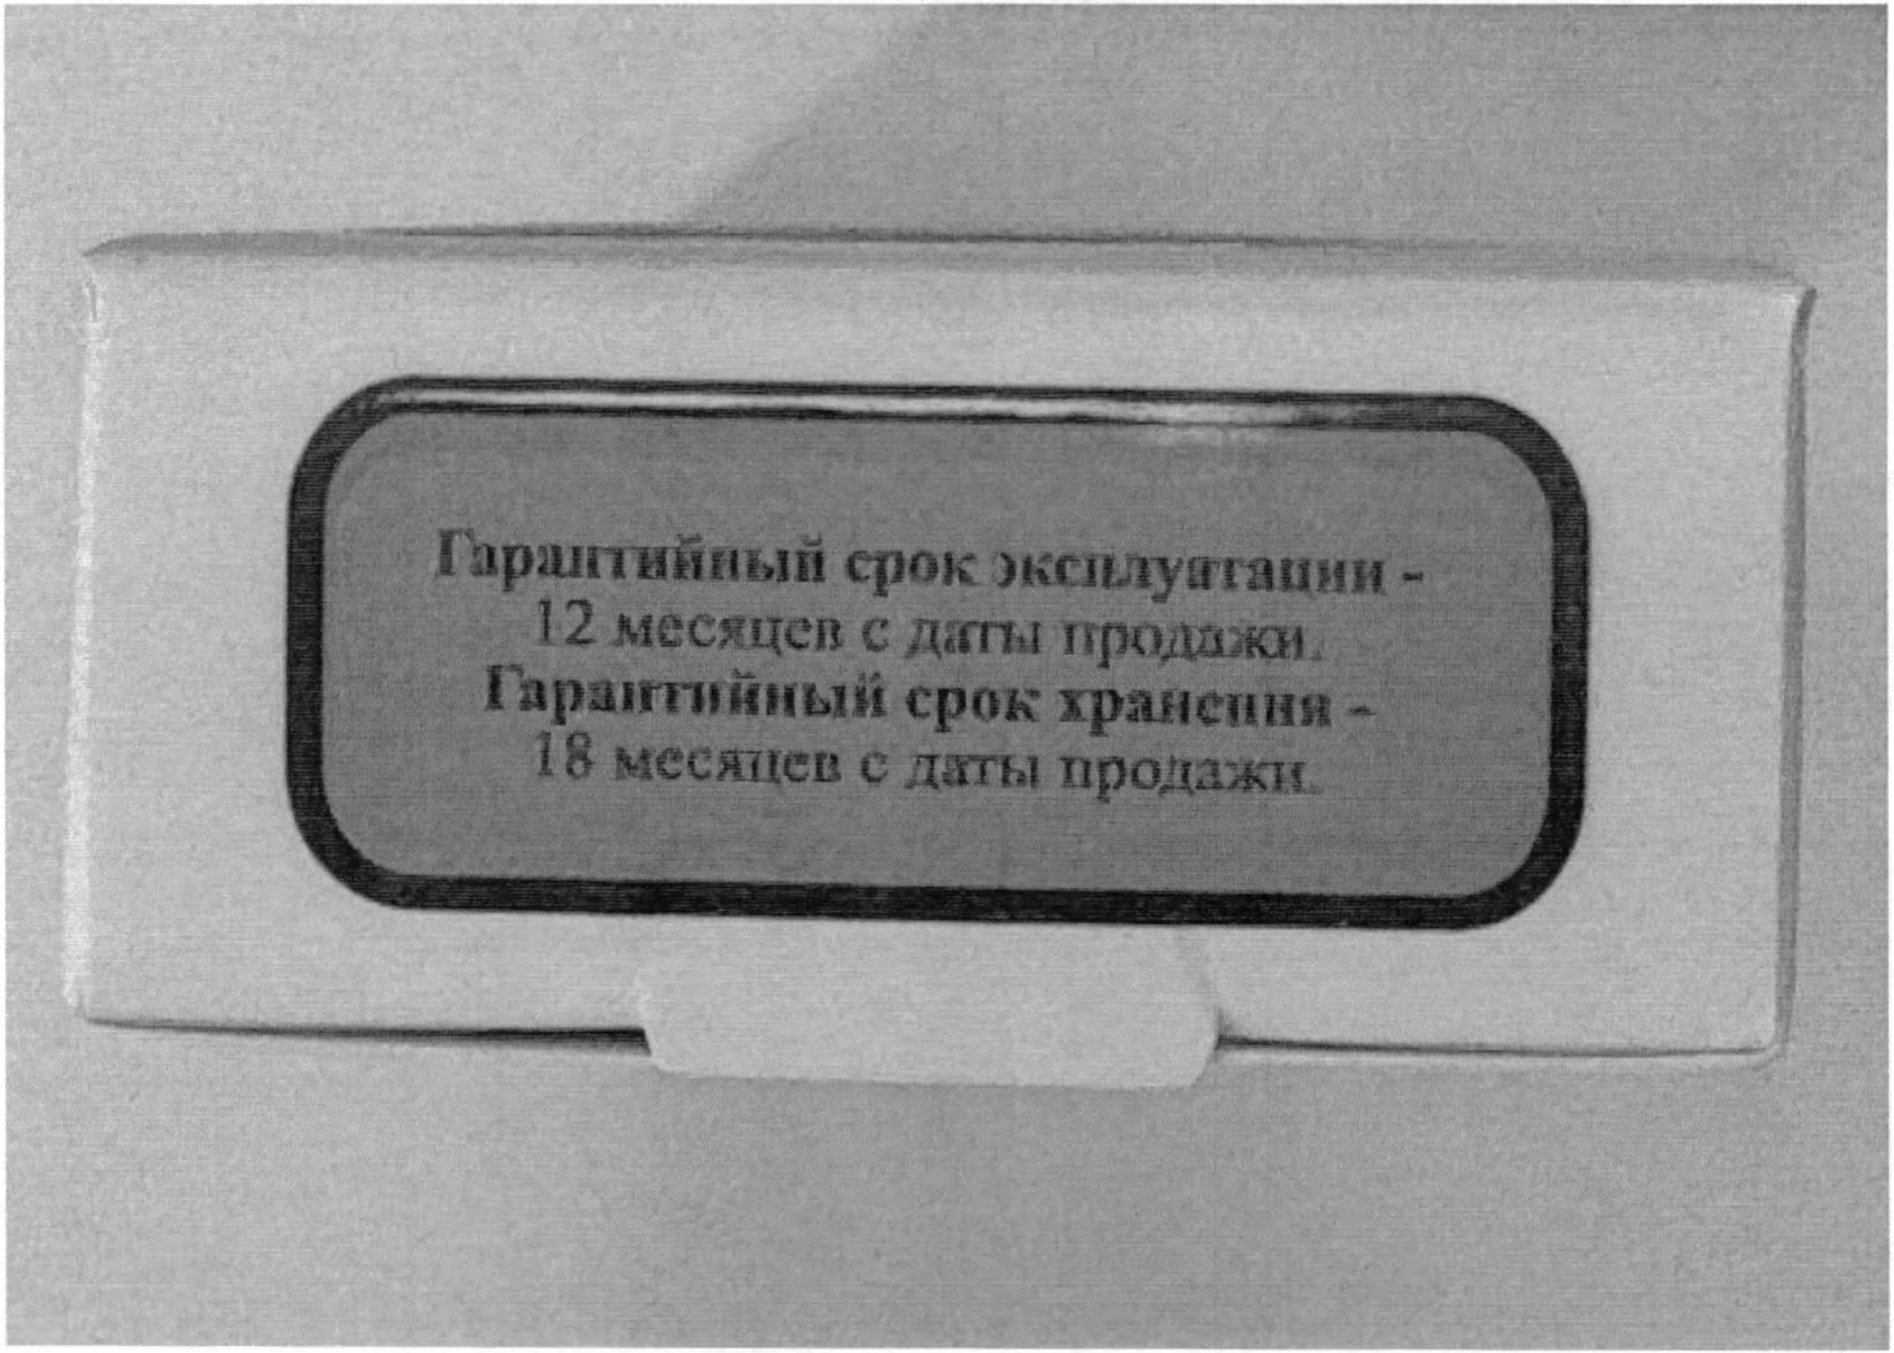

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 5W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

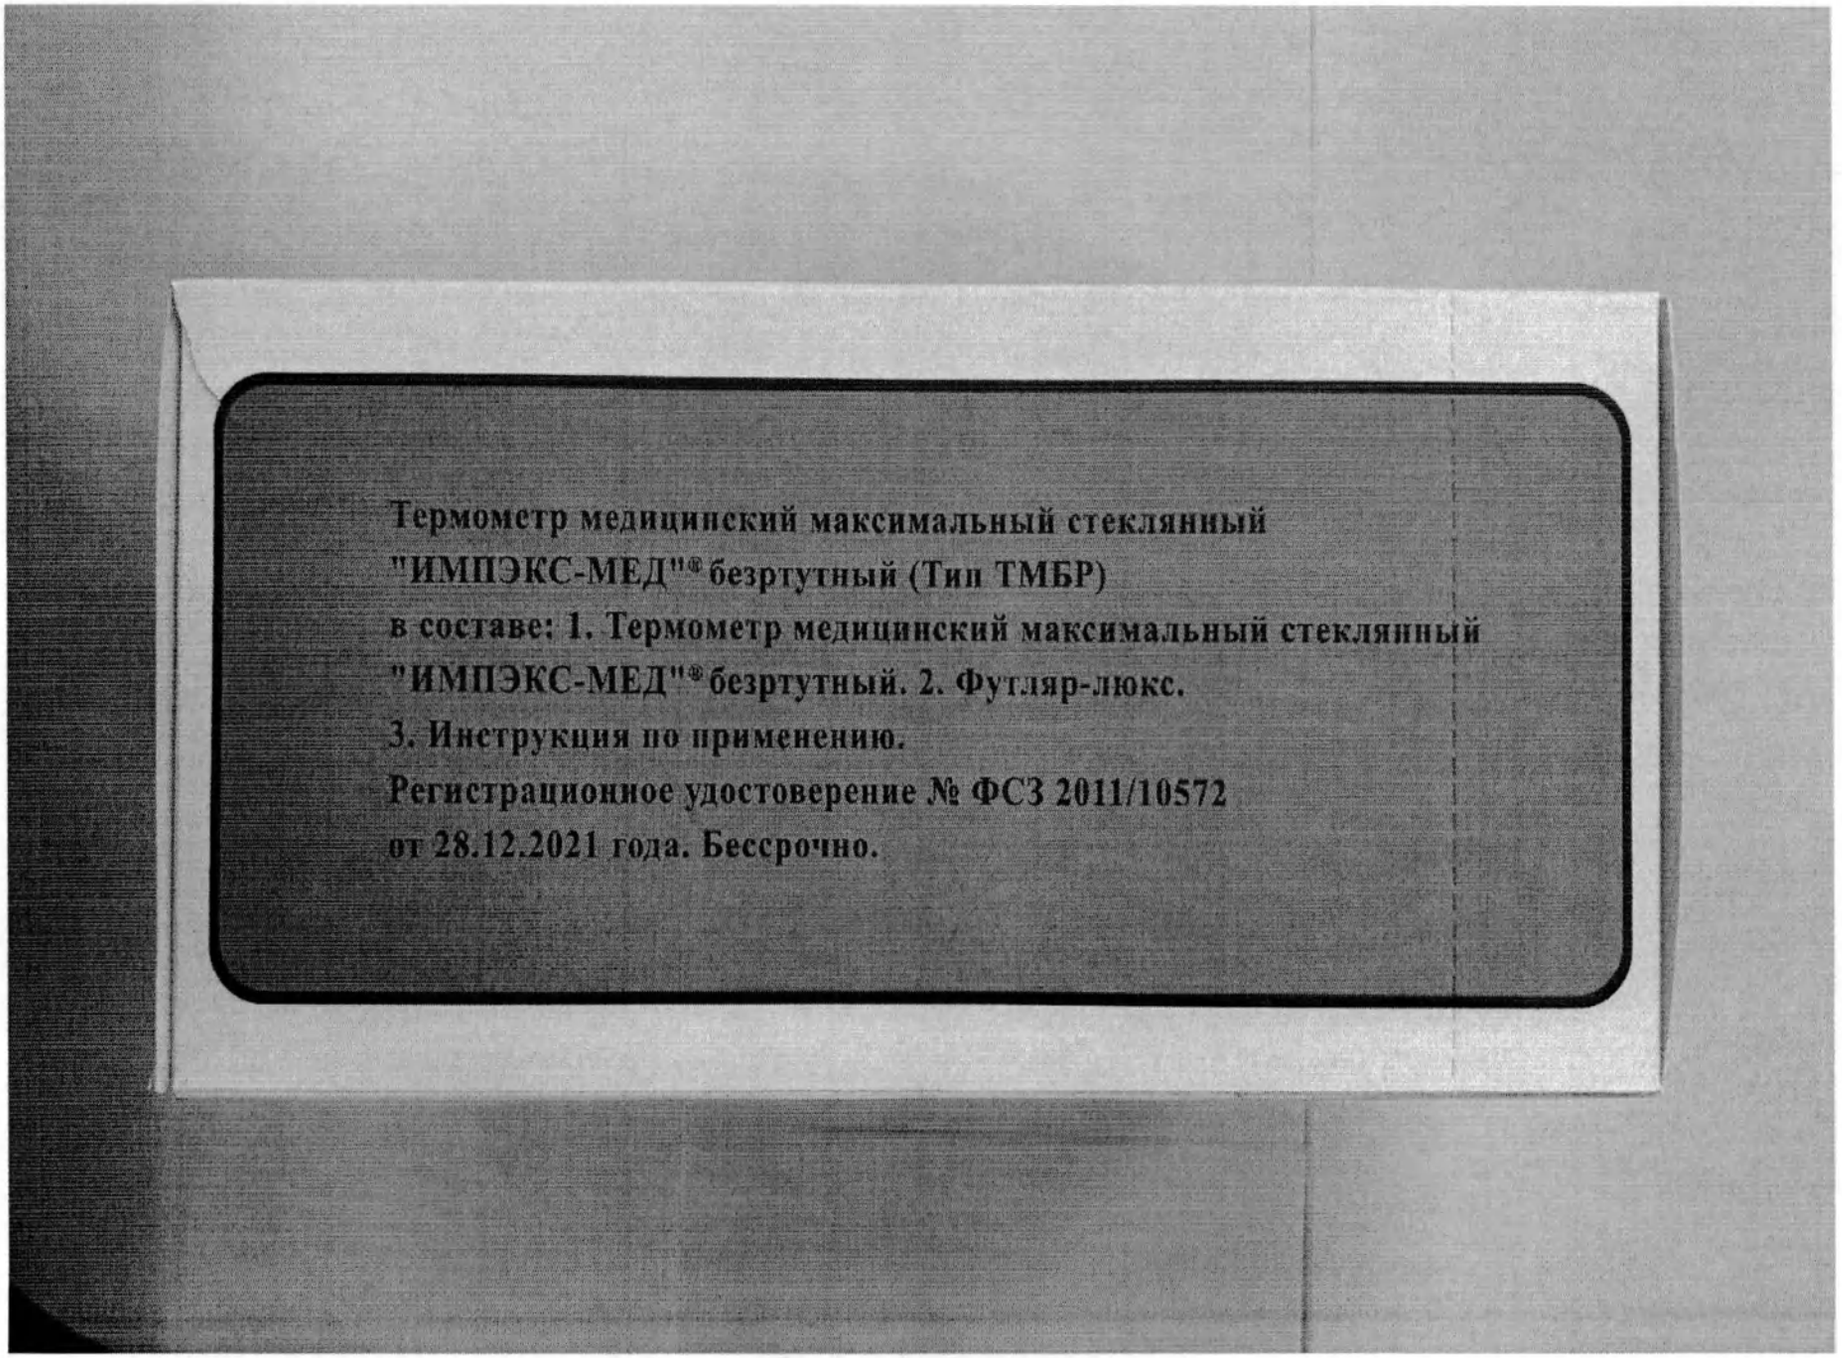

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Thermometer medical
maximum glass
"IMPEX-MED"®
mercury free

Luxe case.
Instruction for use.

MERCURY FREE

Транспортирование и хранение.

Термометры устойчивы к
температурным воздействиям при
транспортировании и хранении.
При транспортировке термометры
укладывают в деревянные ящики или
ящики гофрированного картона
или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров
при хранении и транспортировании. Транспортирование
термометров может производиться любым видом закрытого
транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить
с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных
лучей при температуре внешней среды от +5°С до +42°С.
Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты продажи.

Осторожно стекло!

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР) Футляр классический.

- индивидуальная упаковка 6W:

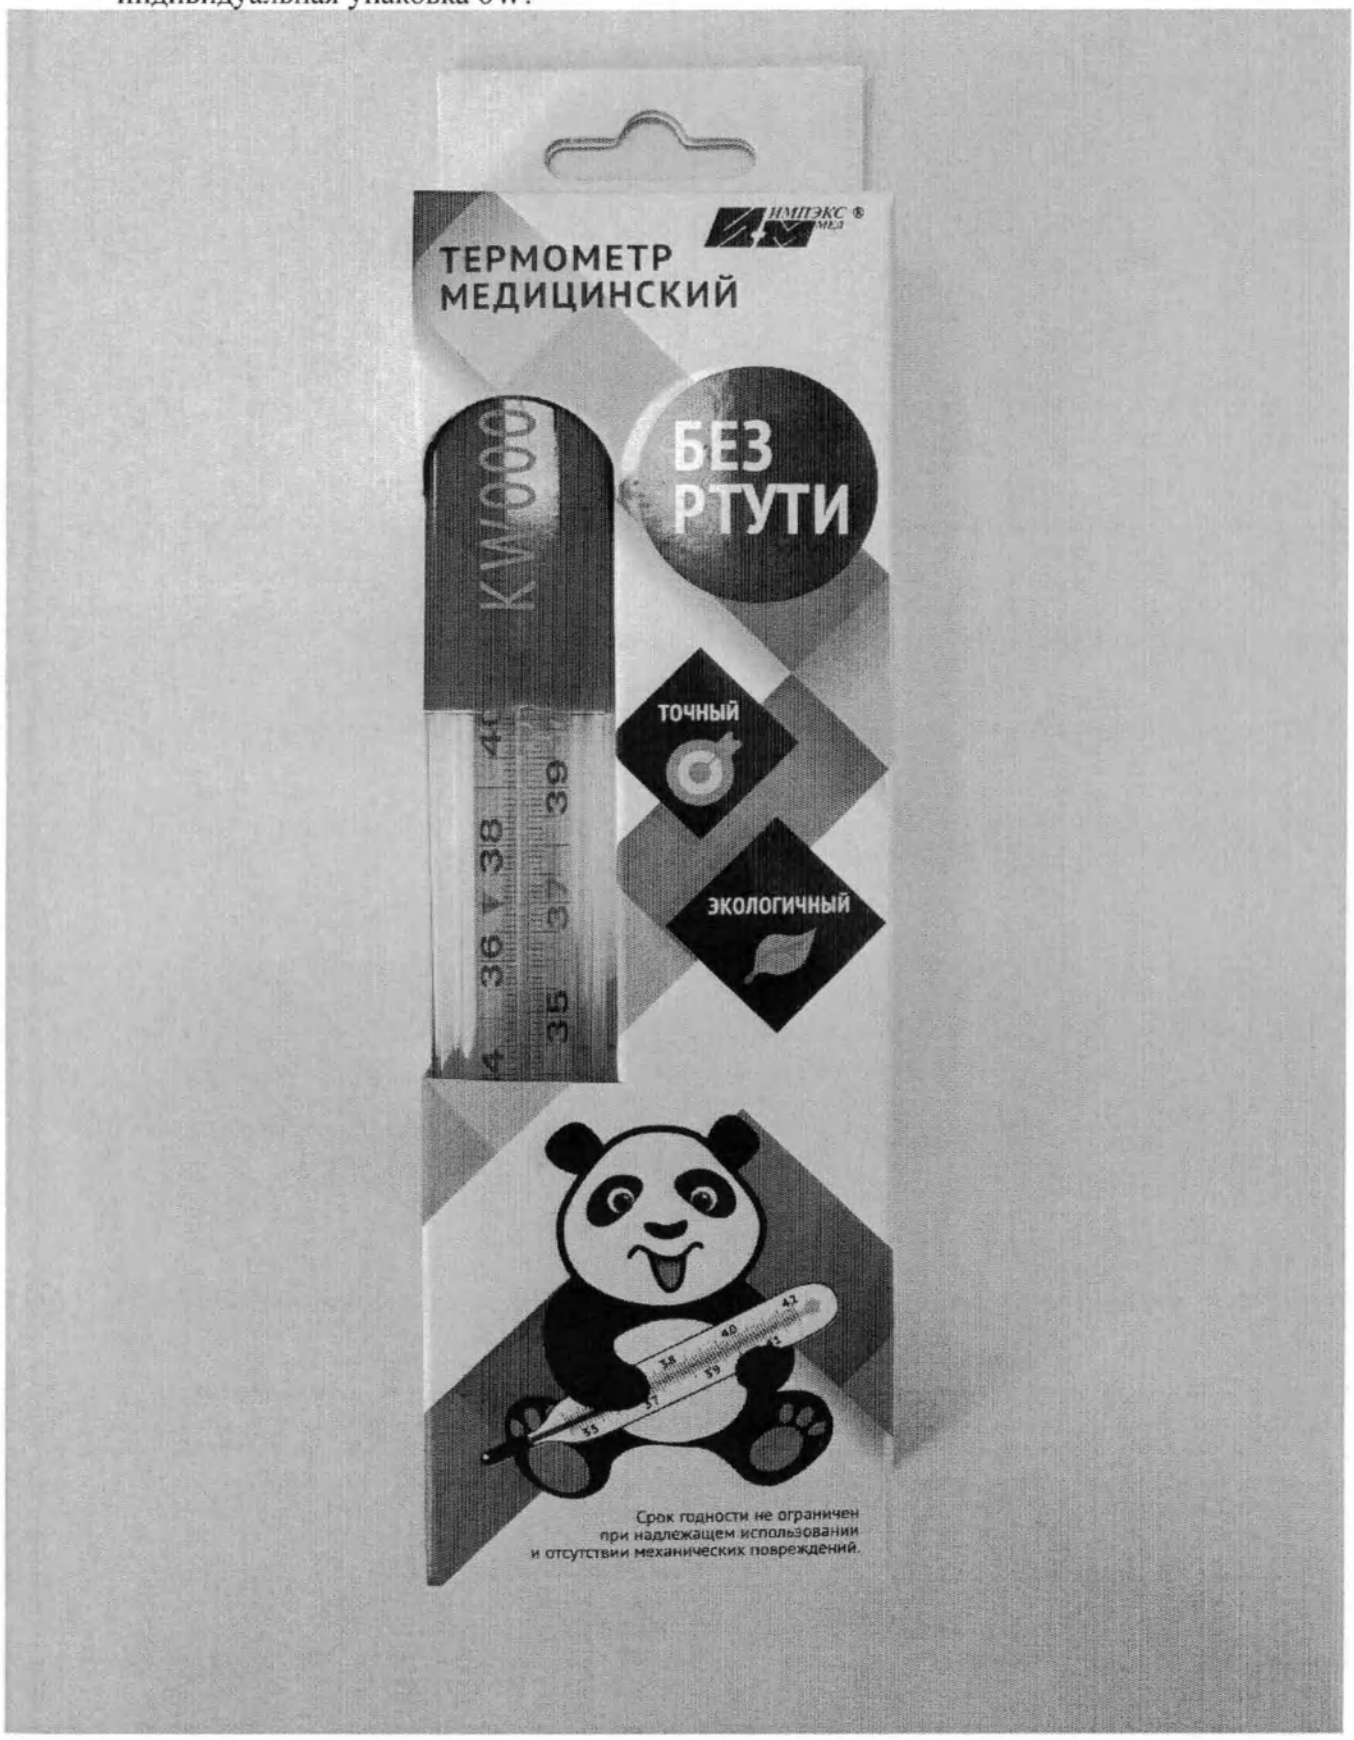

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

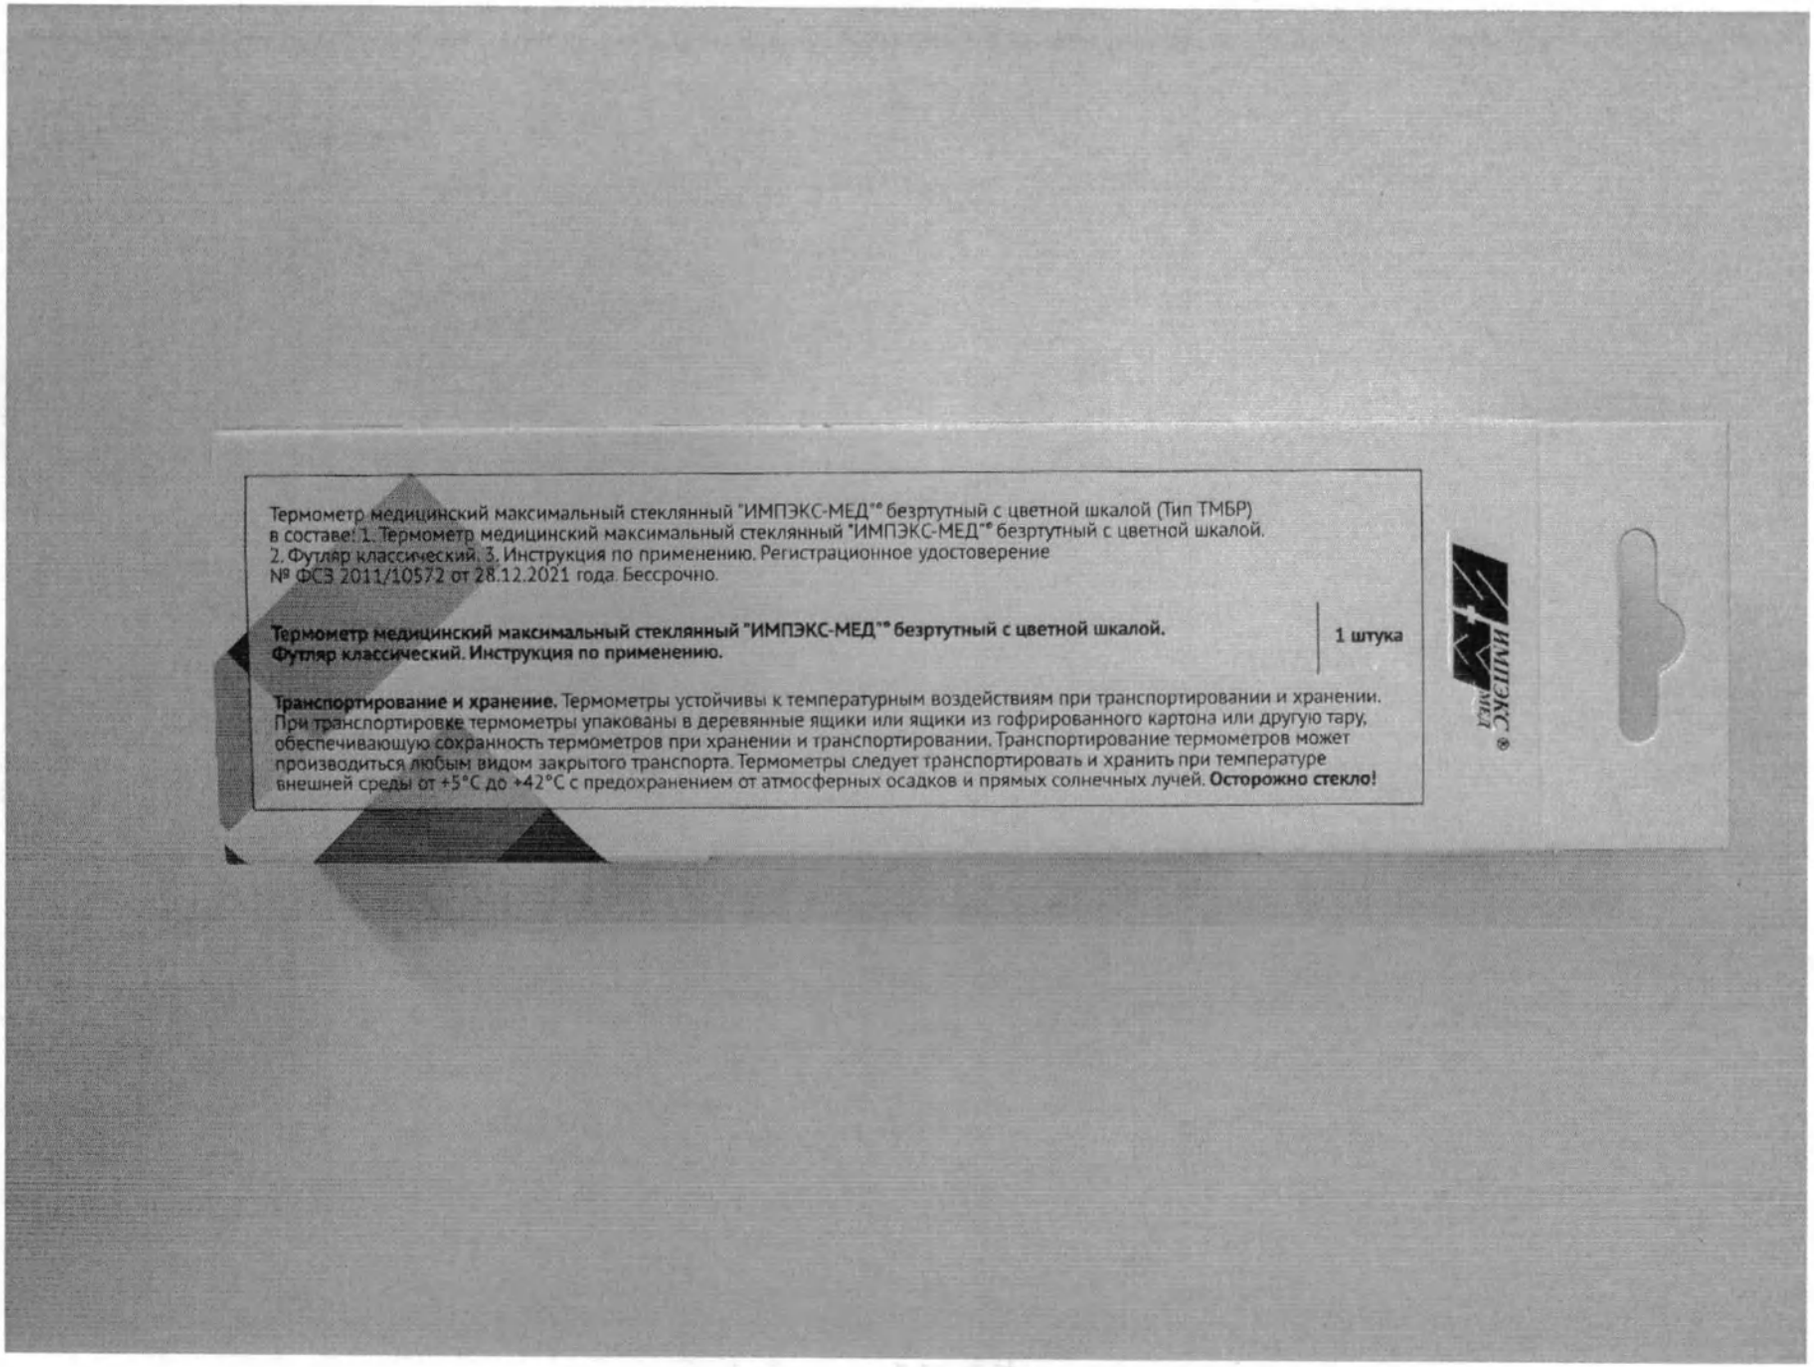

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

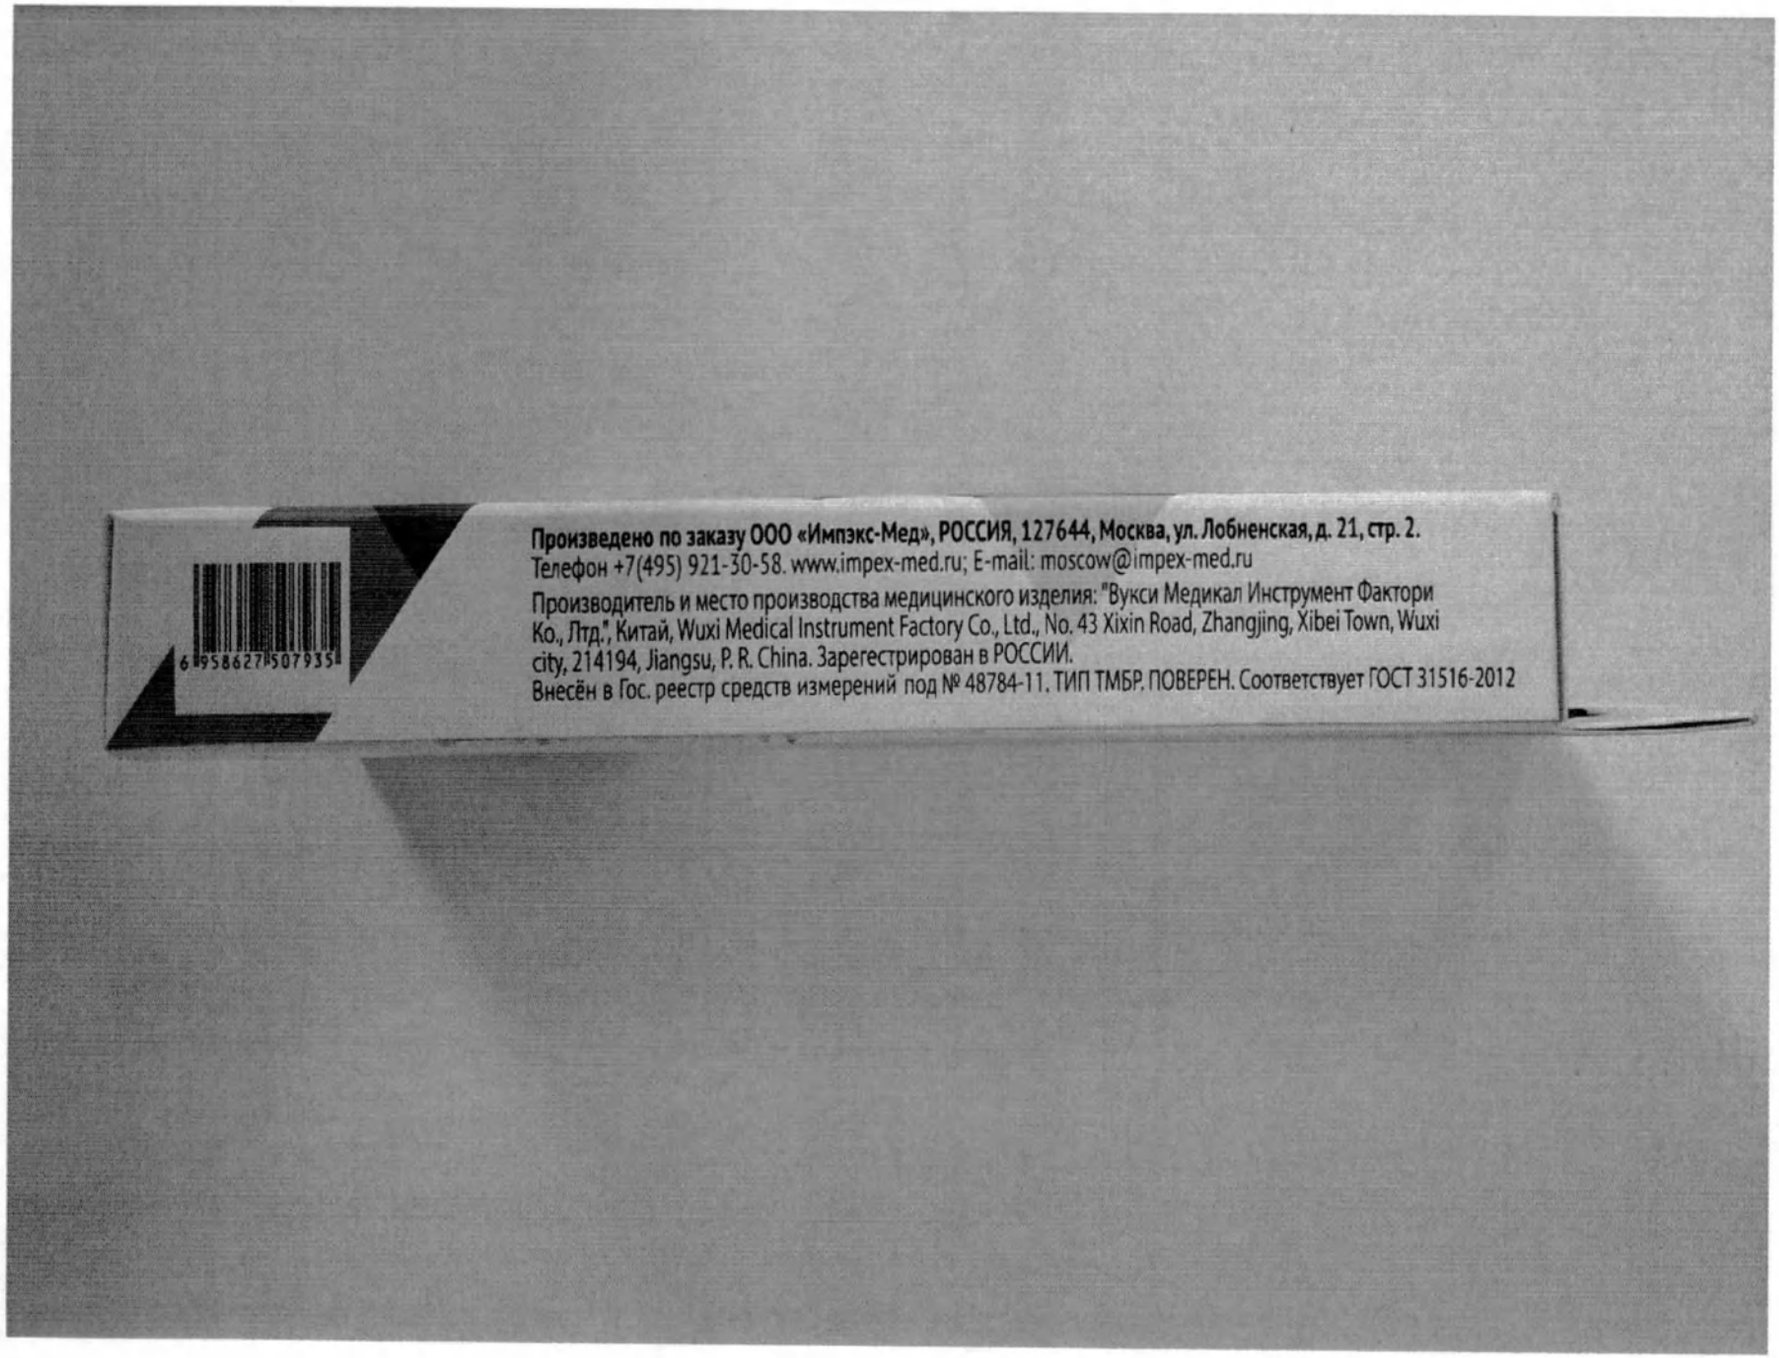

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

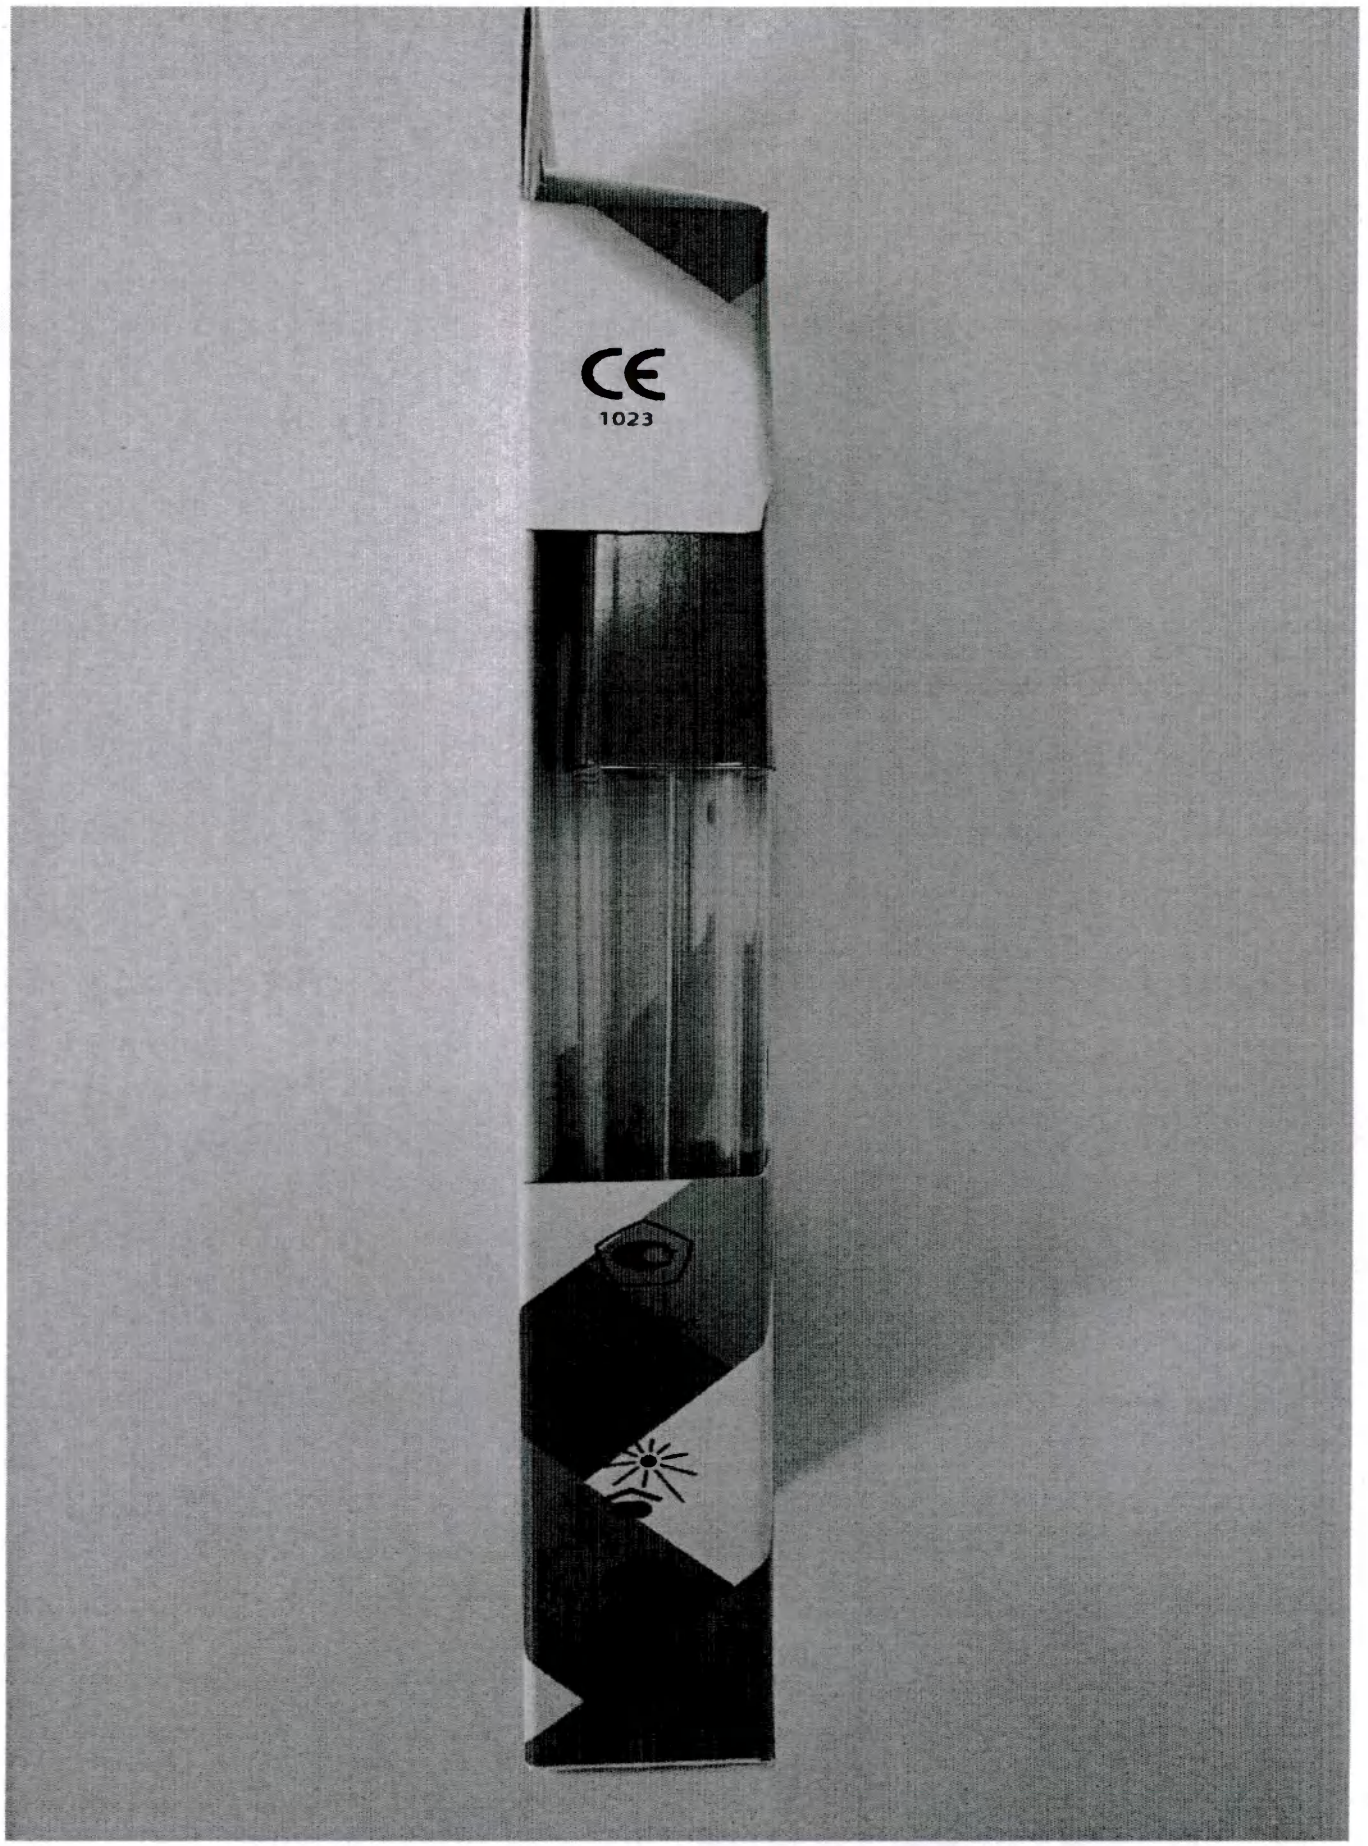

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

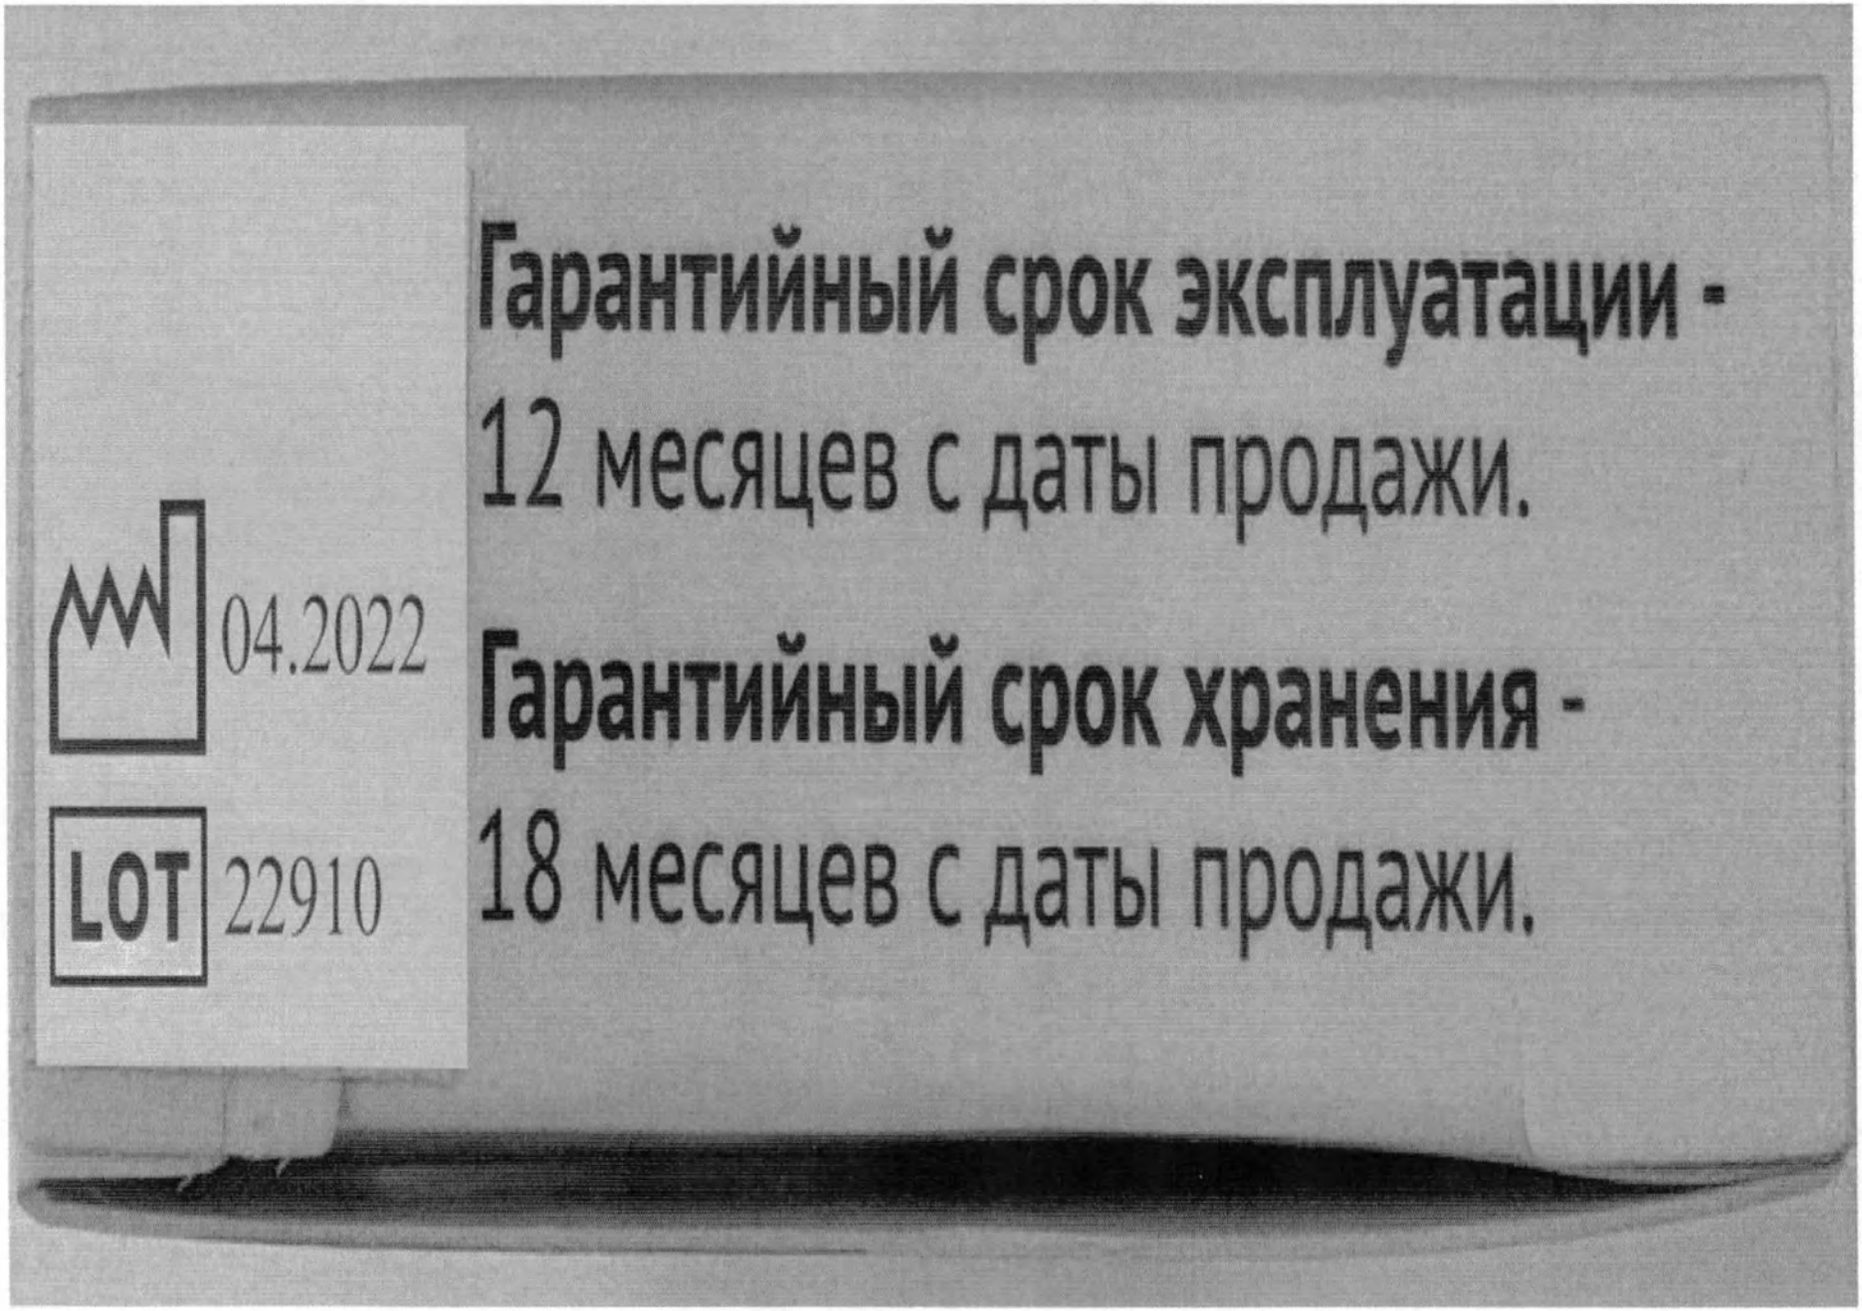

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 6W:

ИМПЭКС МЕД®

6 958627 507935

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой

Футляр классический.
Инструкция по применению.

Thermometer medical
maximum glass
"IMPEX-MED"®
mercury free
with color scale

Classic case.
Instruction for use.

Производитель и место производства медицинского изделия: "Вукси Медикал Инструмент Фактори Ко., Лтд.", Китай, Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd., No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China.

Транспортирование и хранение.
Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении.
При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании.
Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре внешней среды от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Осторожно стекло!

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

Срок годности не ограничен при надлежащем использовании и отсутствии механических повреждений

Зарегистрирован в РОССИИ
Внесён в Гос. реестр средств измерений
под № 48784-11. ПОВЕРЕН. ТИП ТМБР

Термометр соответсвует ГОСТ 31516-2012

Индивидуальная упаковка

БЕЗ РТУТИ

Произведено по заказу
ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ,
127644, Москва, ул. Лобненская,
д. 21, стр. 2.
Телефон +7(495) 921-30-58.
www.impex-med.ru;
E-mail: moscow@impex-med.ru

CE 1023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД ®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

БЕЗ РТУТИ

Гарантийный срок эксплуатации -
12 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок хранения -
18 месяцев с даты продажи.

04.2022

LOT 22910

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

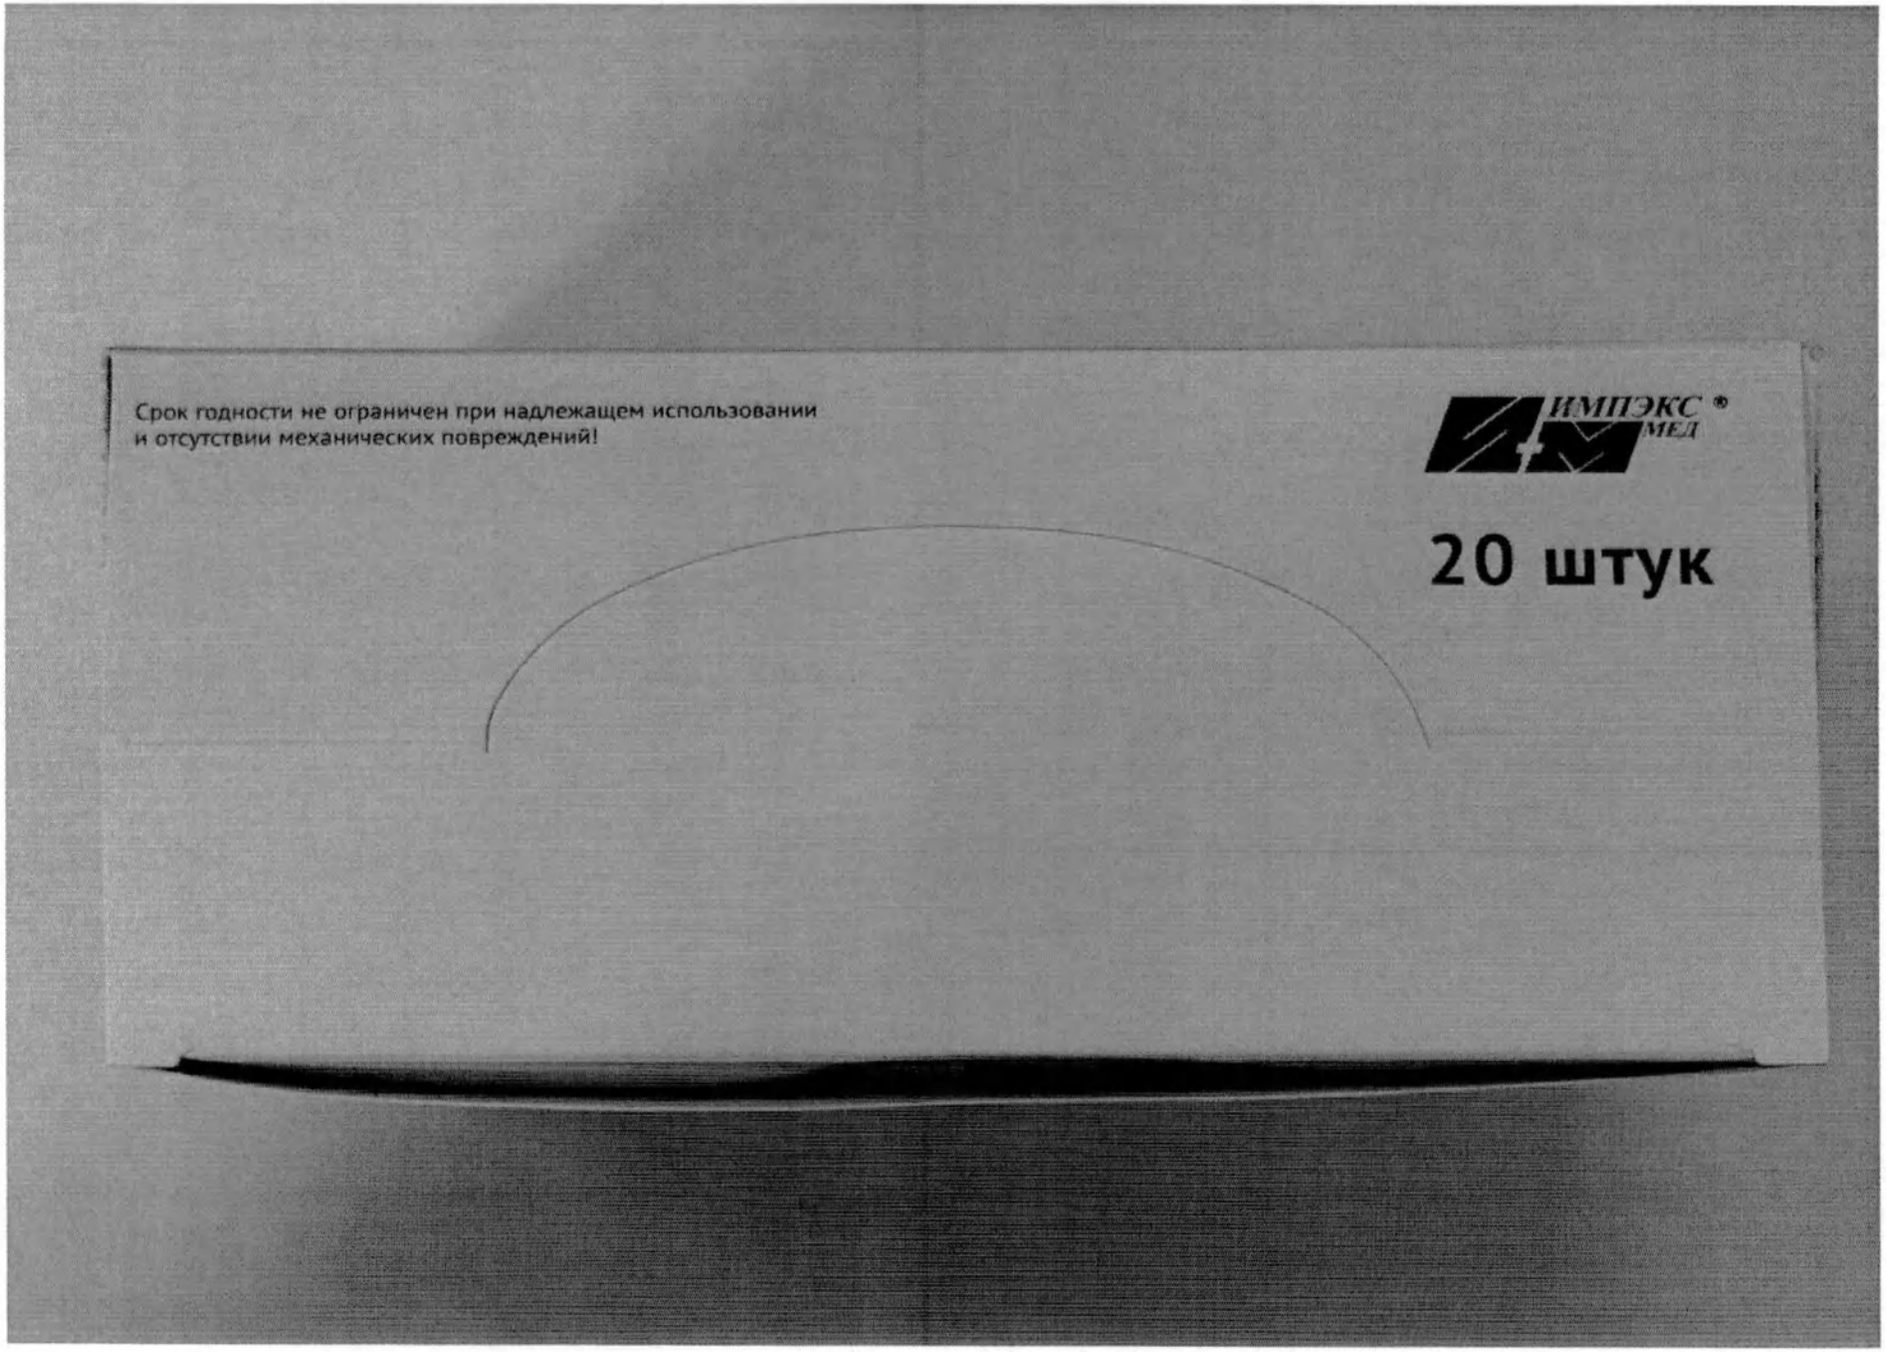

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

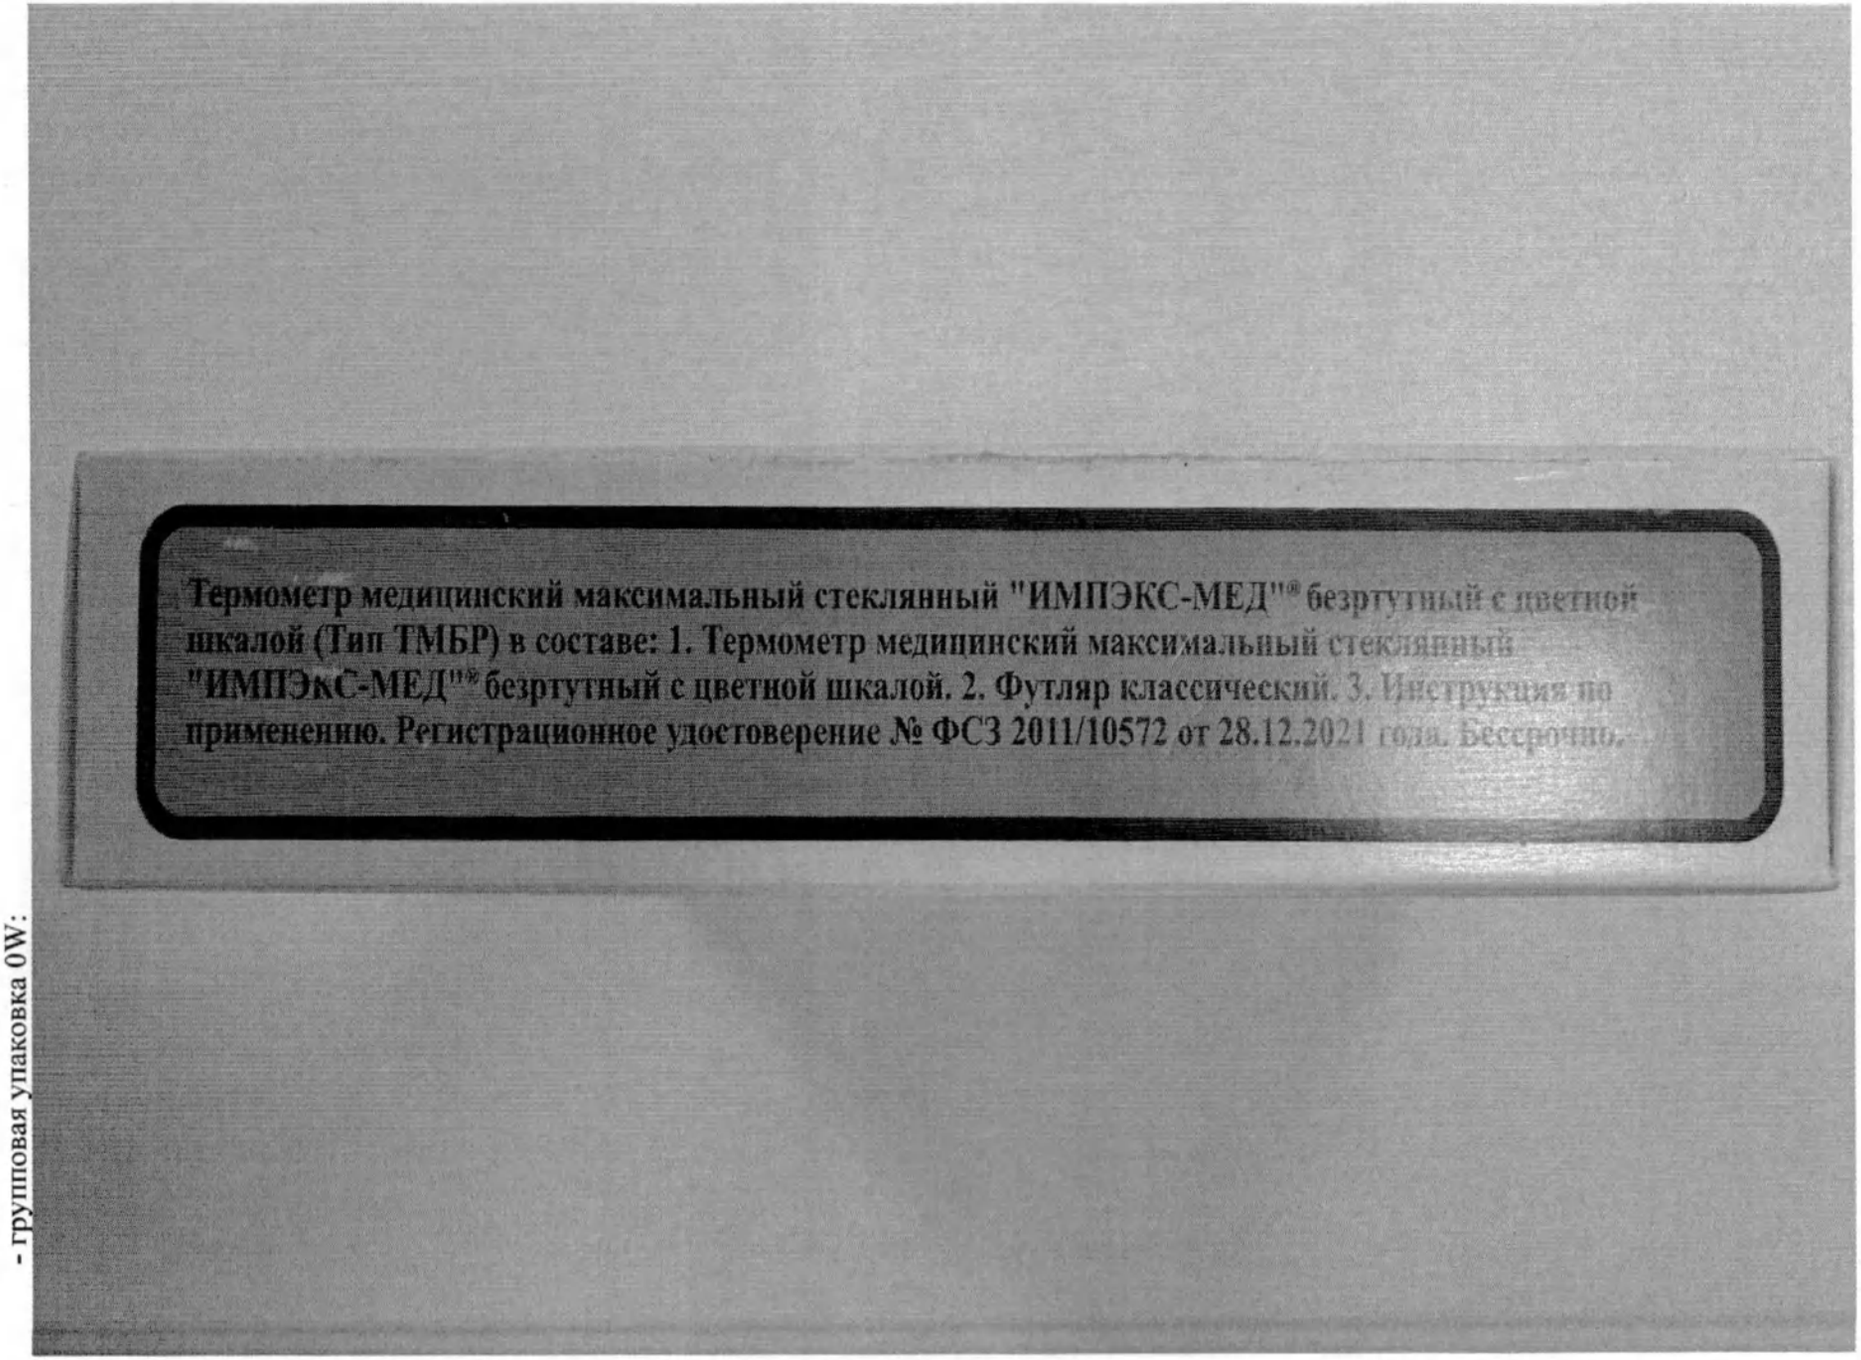

- групповая упаковка 0W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС® МЕД

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой

Футляр классический. Инструкция по применению.

Произведено по заказу ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ,
127644, Москва, ул. Лобненская, д. 21, стр. 2.
Телефон/факс многоканальный +7(495) 921-30-58.
www.impex-med.ru; E-mail: moscow@impex-med.ru

БЕЗ РТУТИ



цветная шкала для более наглядного считывания температуры

Производитель и место производства медицинского изделия: "Вукси Медикал Инструмент Фактори Ко., Лтд.", Китай, Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd., No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China.

CE 1023

Термометр соответсвует ГОСТ 31516-2012.
Зарегестрирован в РОССИИ.
Внесён в Гос. реестр средств измерений под № 48784-11. Поверен. Тип ТМБР

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД

Thermometer medical maximum glass "IMPEX-MED"® mercury free with color scale

цветная шкала для более наглядного считывания температуры

Classic case. Instruction for use.

MERCURY FREE

Транспортирование и хранение.

Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта.

Термометры следует транспортировать и хранить при температуре внешней среды от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты продажи.

⚠ Осторожно стекло!

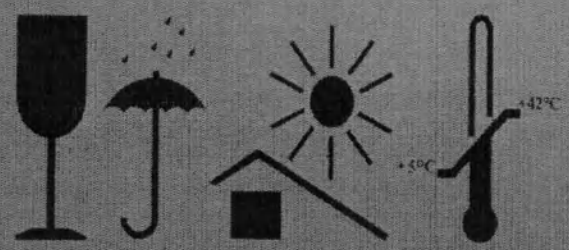

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

LOT 22910

04.2022

6 958627 514001

ИМПЭКС МЕД

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР) Футляр для легкого встряхивания.

- индивидуальная упаковка 7W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

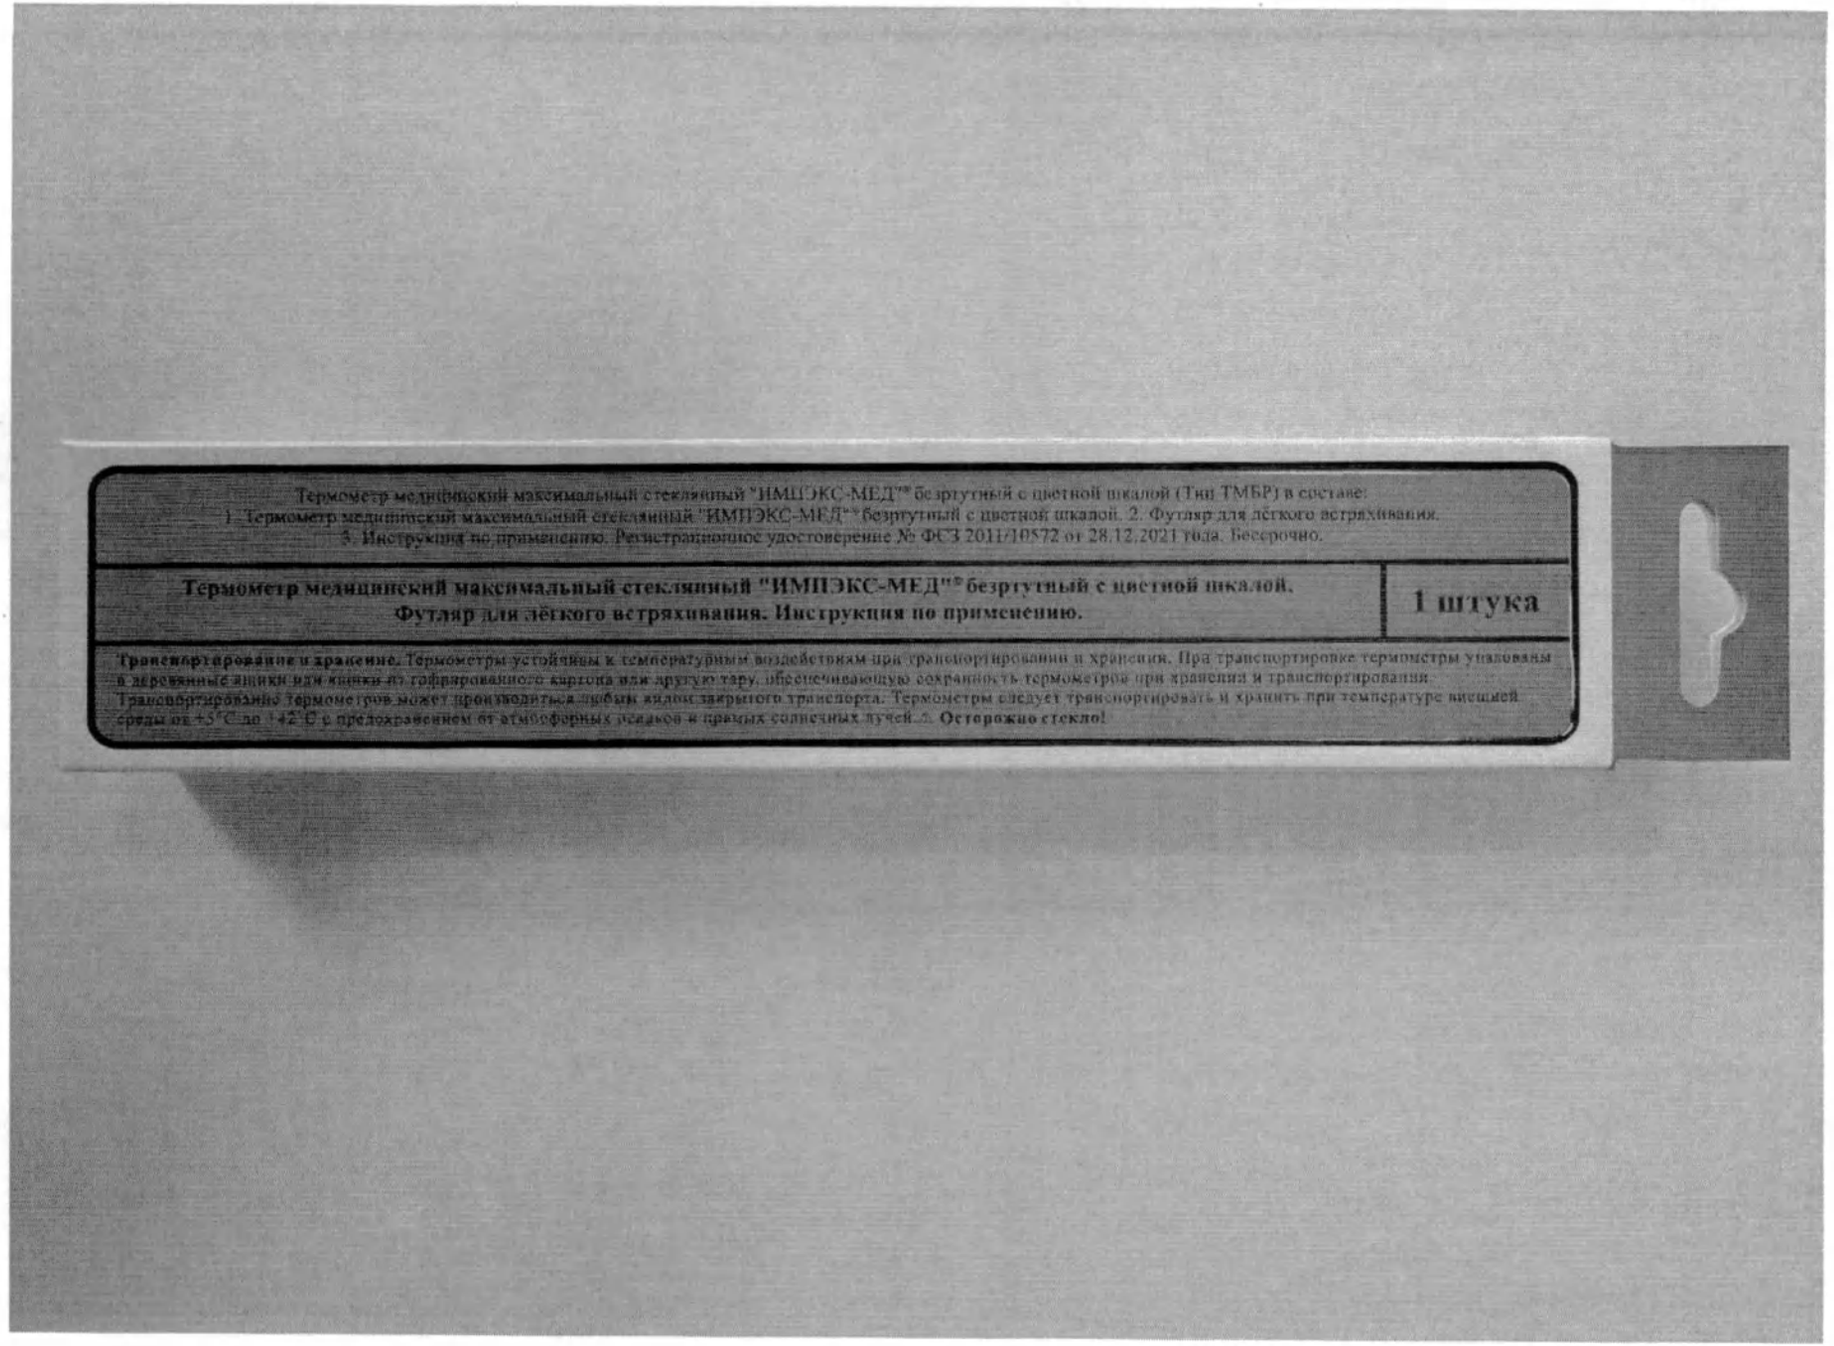

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

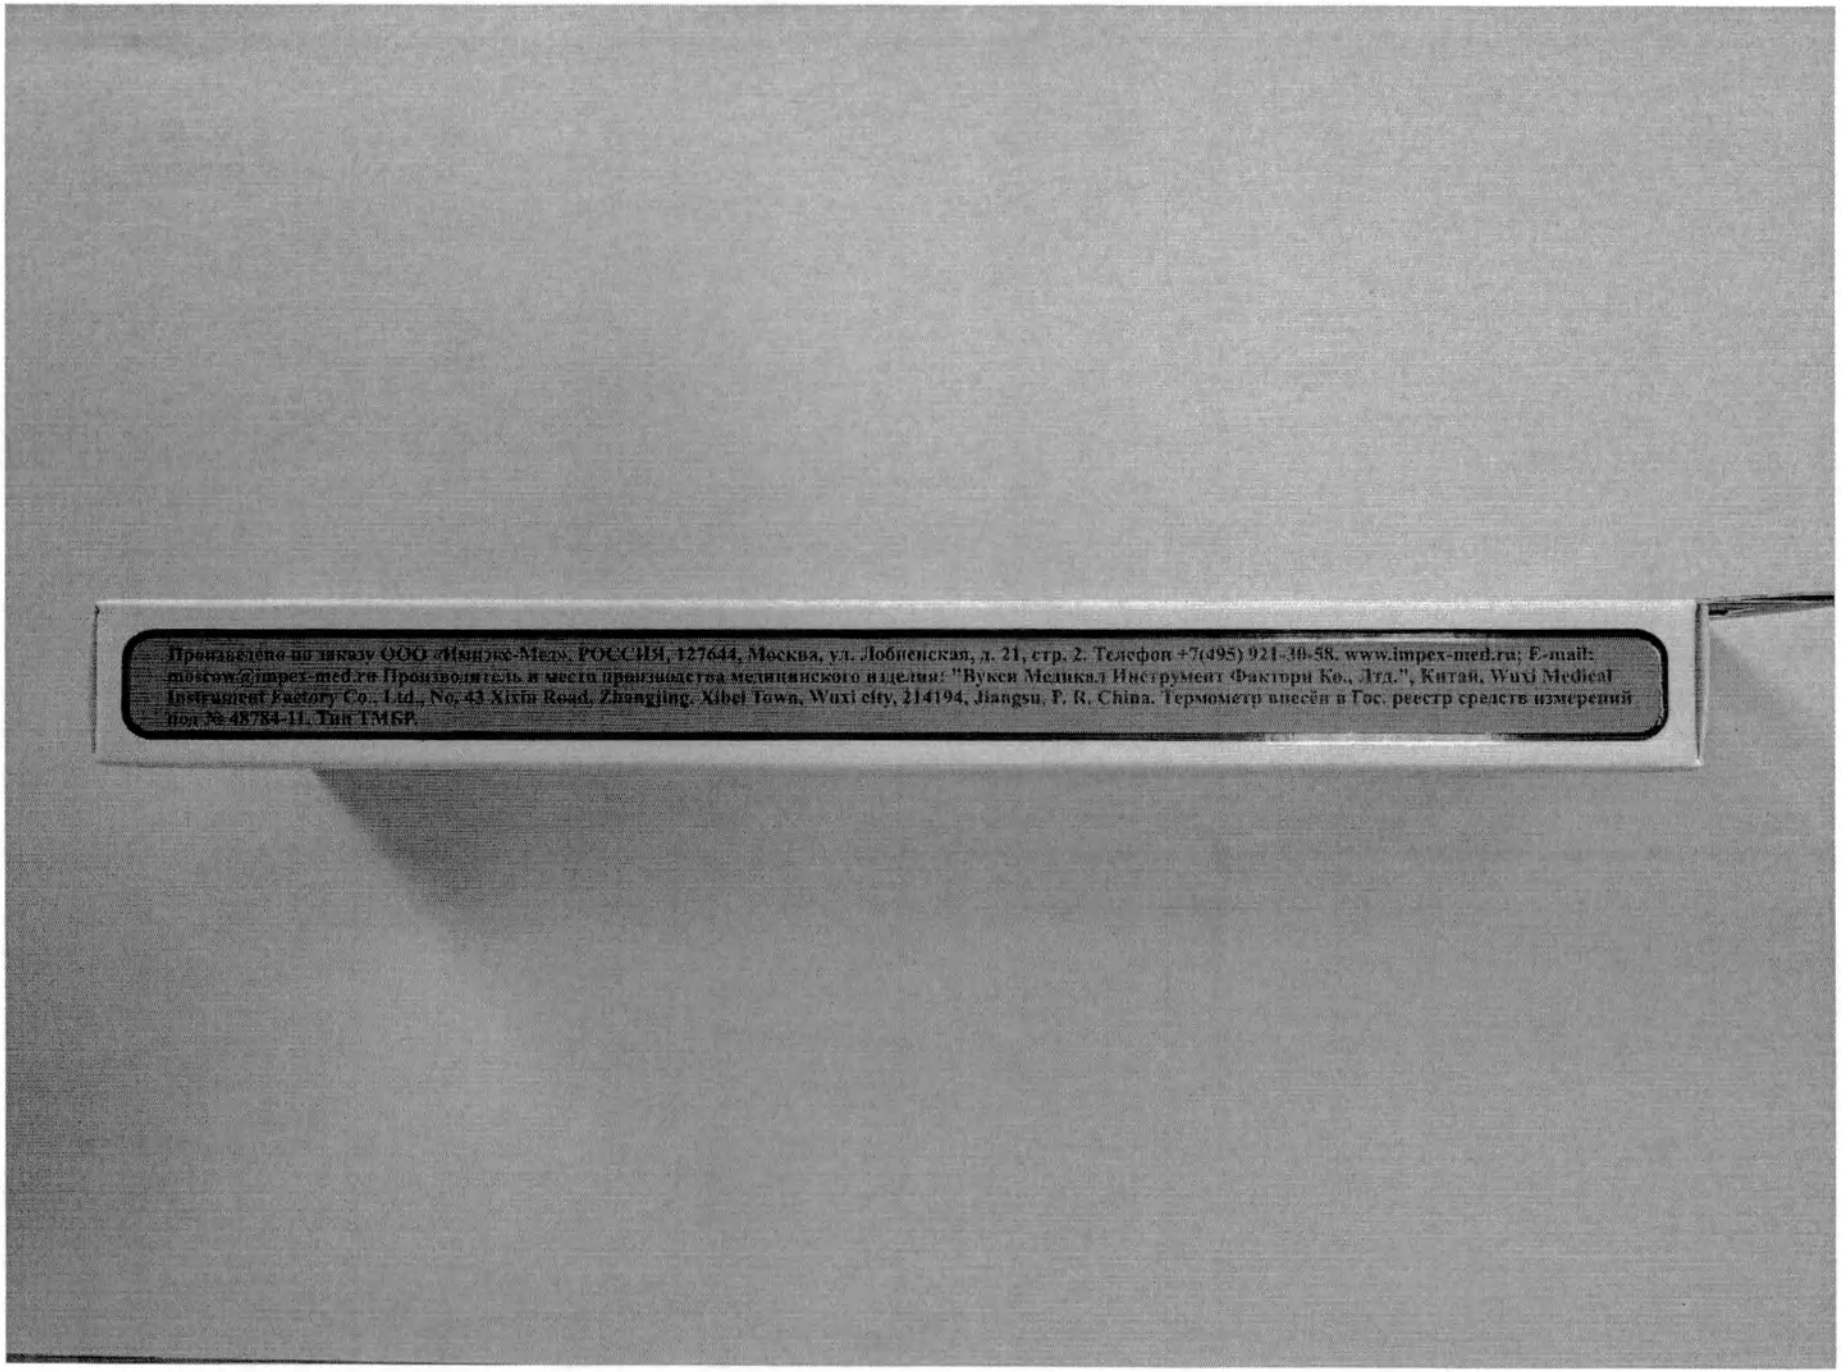

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 7W:

ИМПЭКС® МЕД

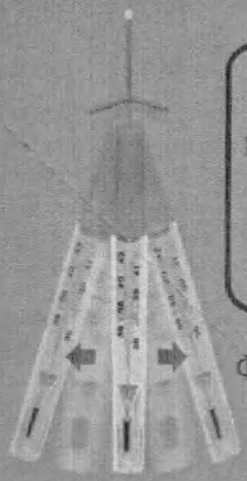

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой



Футляр для лёгкого встряхивания.

Инструкция по применению.

Произведено по заказу
ООО «Импэкс-Мед», РОССИЯ,
127644, Москва, ул. Лобненская,
д. 21, стр. 2.
Телефон +7(495) 921-30-58.
www.impex-med.ru;
E-mail: moscow@impex-med.ru

БЕЗ РТУТИ

CE 1023

Производитель и место производства медицинского изделия: "Вукси Медикал Инструмент Фактори Ко., Лтд.", Китай, Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd., No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China.

Термометр соответсвует ГОСТ 31516-2012.
Зарегестрирован в РОССИИ.
Внесён в Гос. реестр средств измерений под № 48784-11. Поверен. Тип ТМБР

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР)
в составе: 1. Термометр медицинский максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой. 2. Футляр
для лёгкого встряхивания. 3. Инструкция по применению.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572
от 28.12.2021 года. Бессрочно.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД®

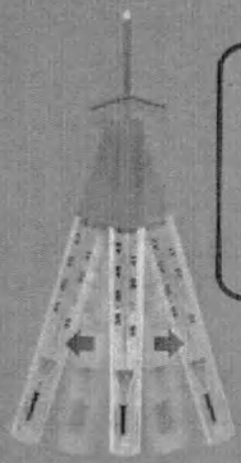

Thermometer medical maximum glass "IMPEX-MED"® mercury free with color scale



Case for easy shaking.

Instruction for use.

MERCURY FREE

Транспортирование и хранение.
Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики изгофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре внешней среды от +5°С до +42°С. Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты продажи.

⚠ **Осторожно стекло!**

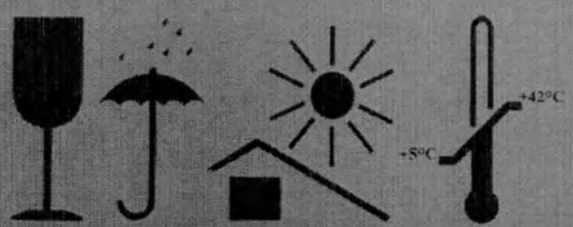

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД®

6 958627 507942

04.2022

LOT 22910

ТЕРМОМЕТР БЕЗ РТУТИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР) Футляр-лупа.

- индивидуальная упаковка 8W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

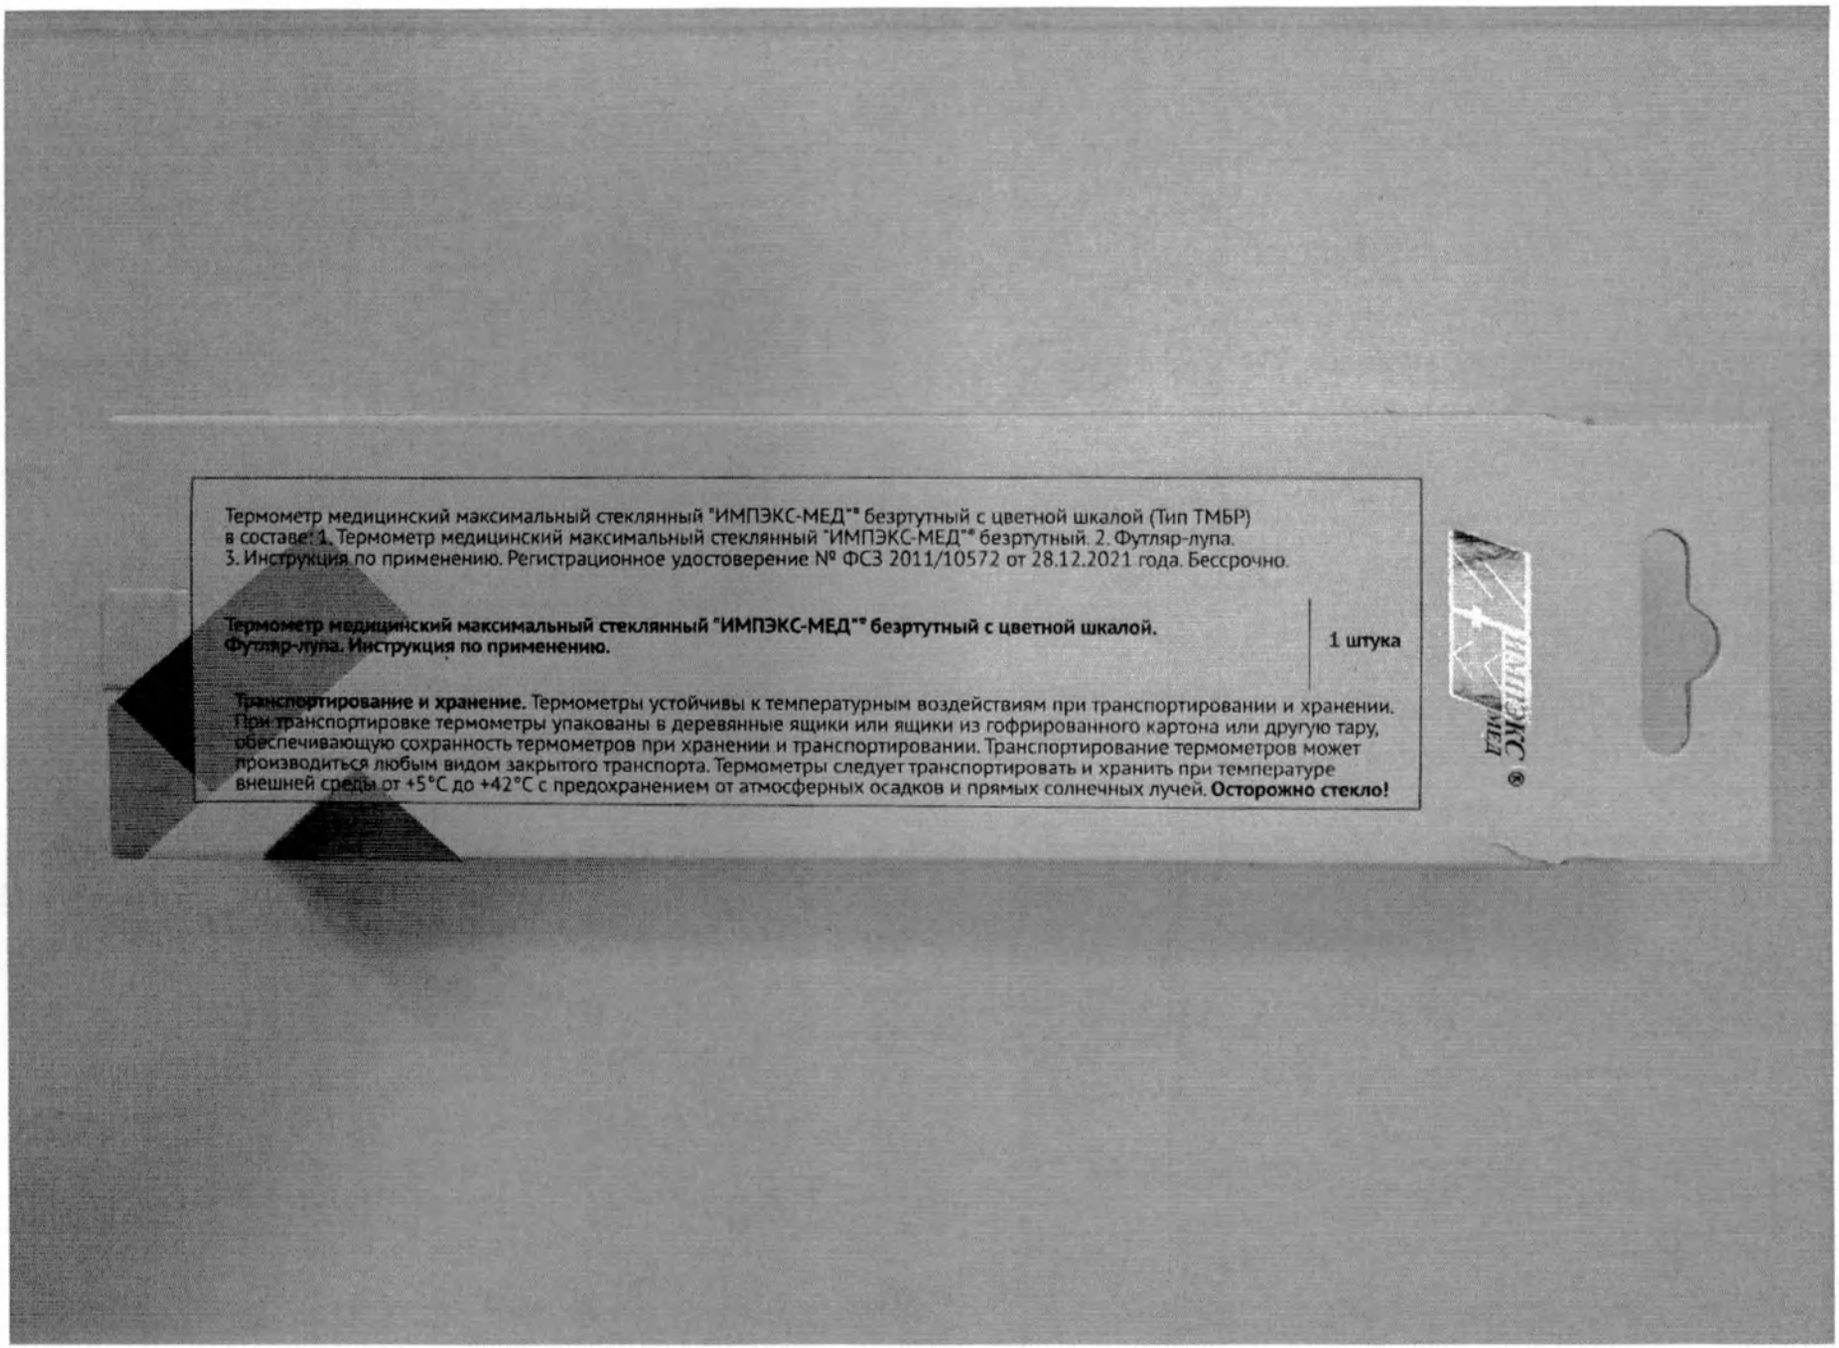

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

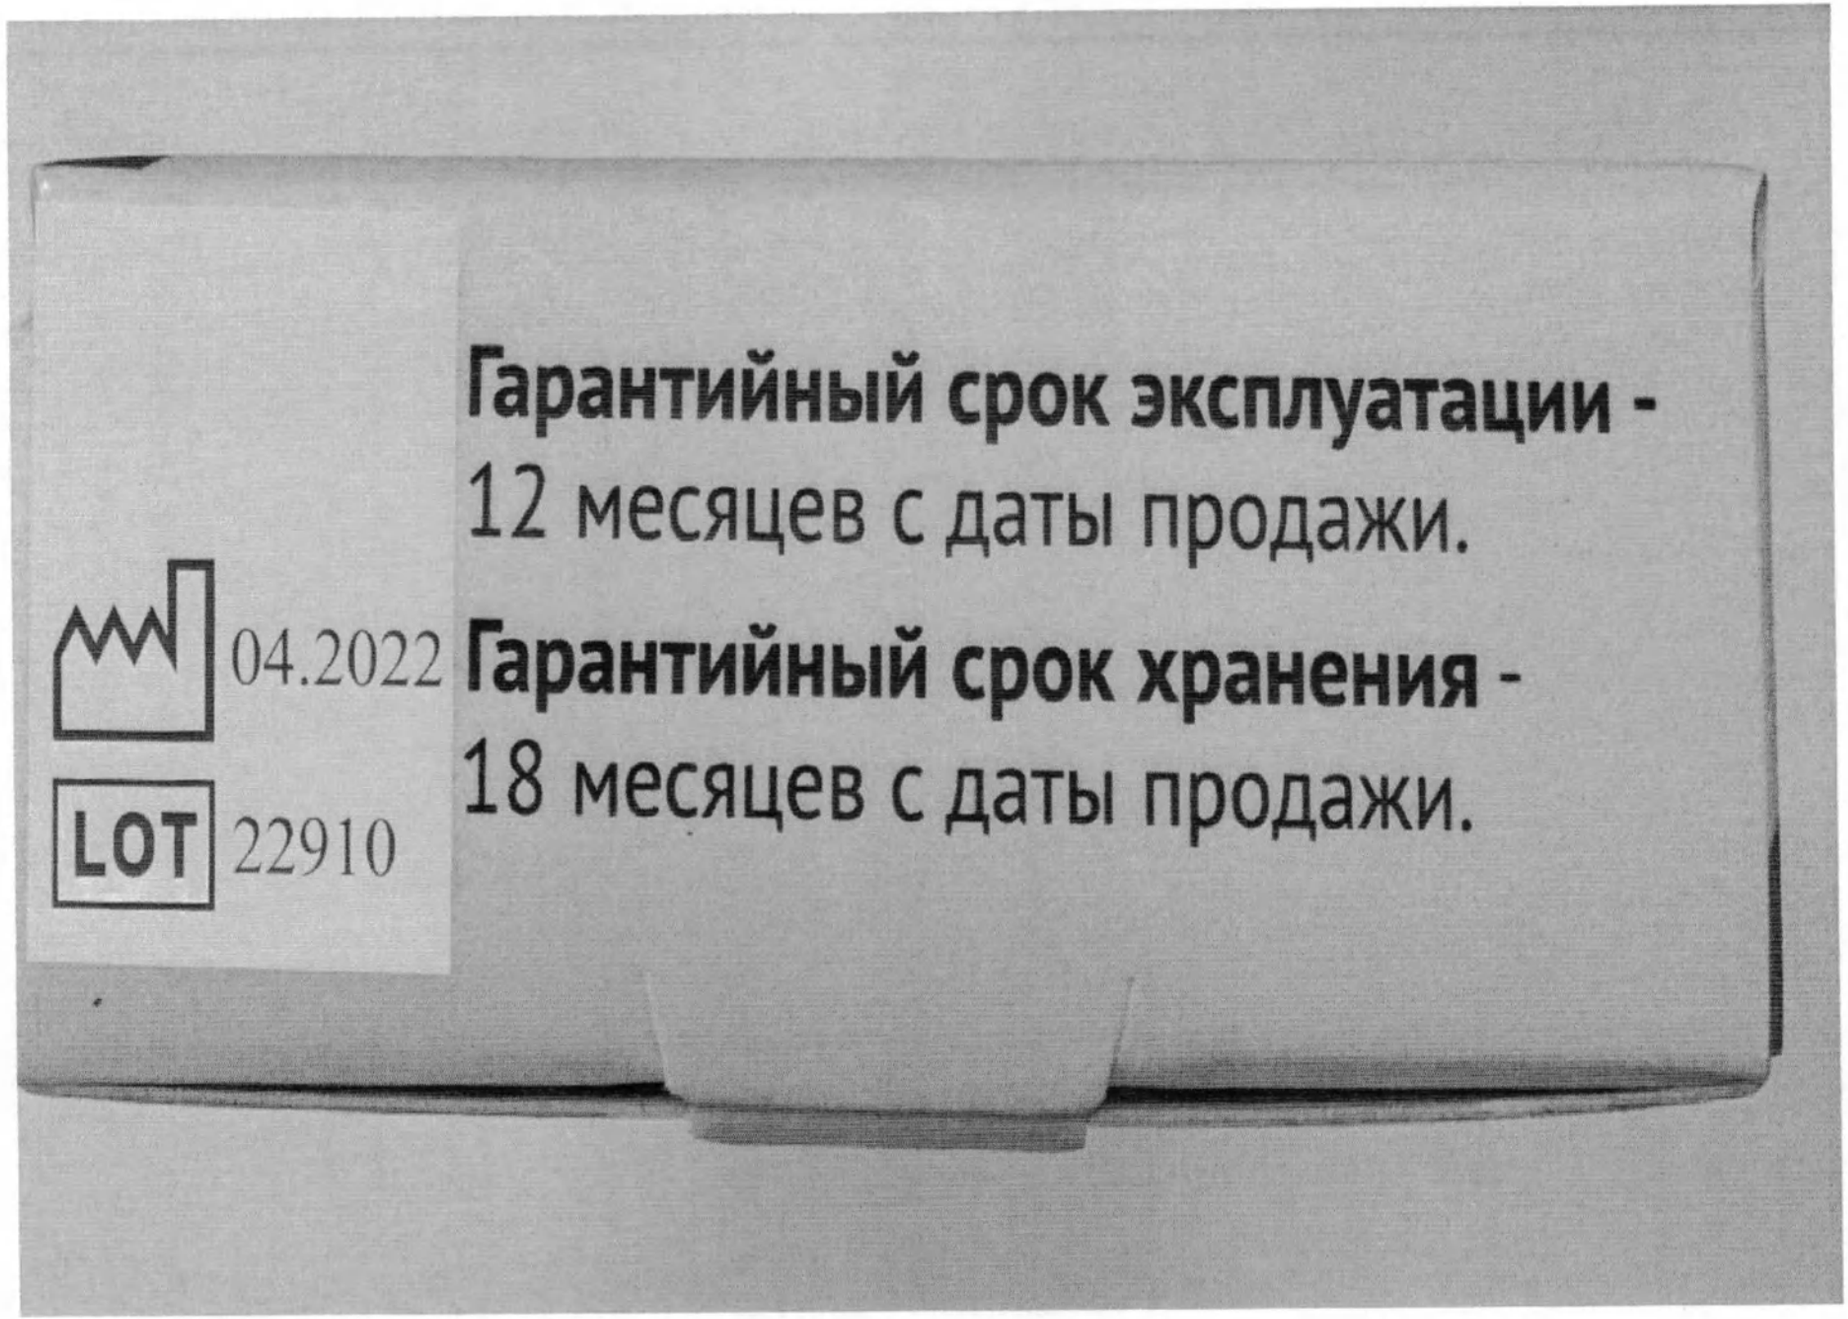

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 8W:

ИМПЭКС МЕД®

6 958627 507959

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ максимальный стеклянный "ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой

Футляр-лупа.
Инструкция по применению.

Thermometer medical
maximum glass
"IMPEX-MED"®
mercury free
with color scale

Magnifying case.
Instruction for use.

Производитель и место производства медицинского изделия: "Вукси Медикал Инструмент Фактори Ко., Лтд.", Китай, Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd., No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi city, 214194, Jiangsu, P. R. China.

Транспортирование и хранение.
Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении.
При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании.
Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре внешней среды от +5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Осторожно стекло!

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

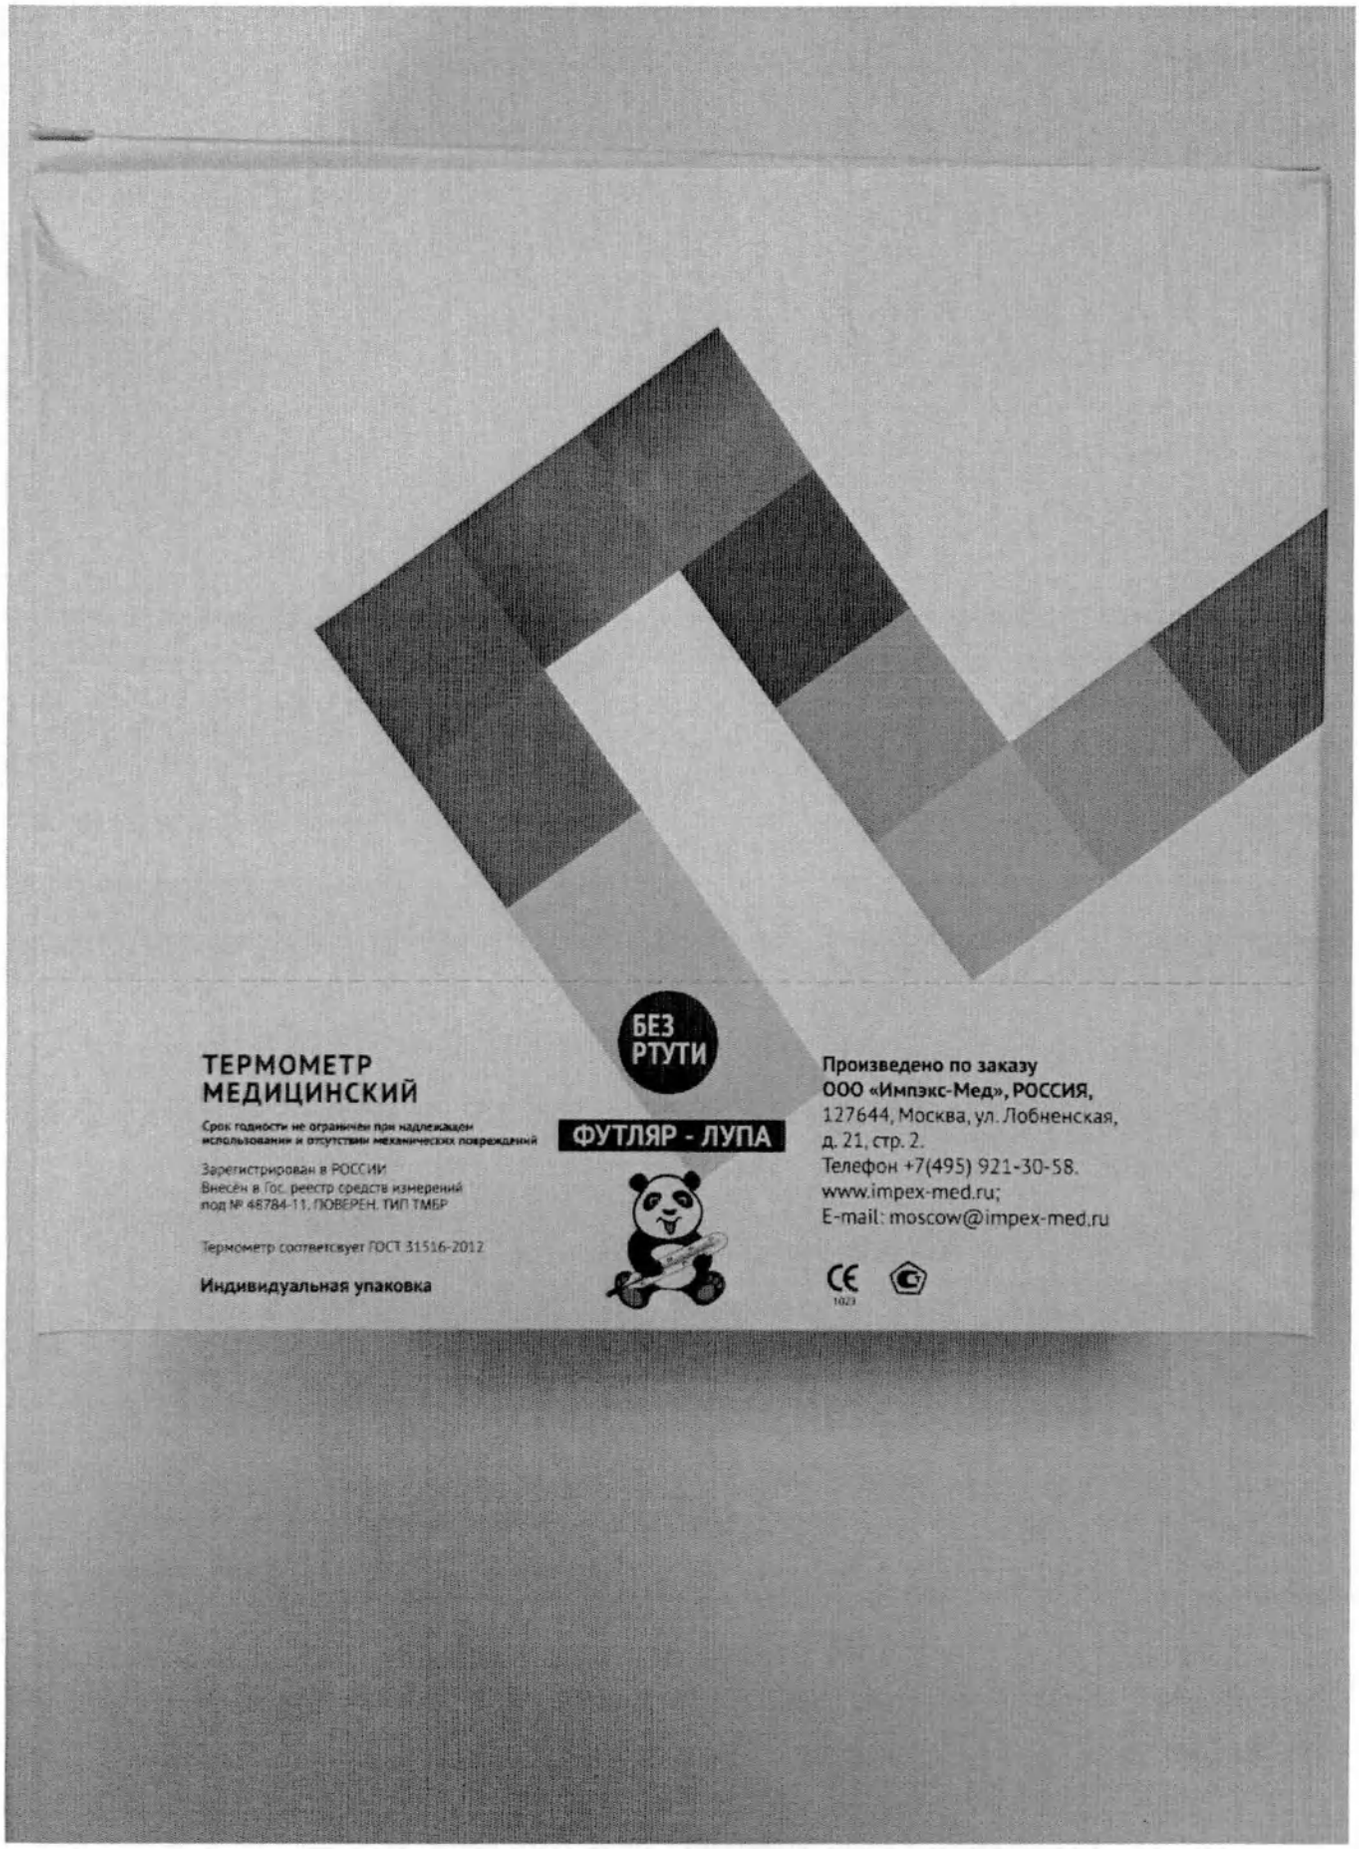

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

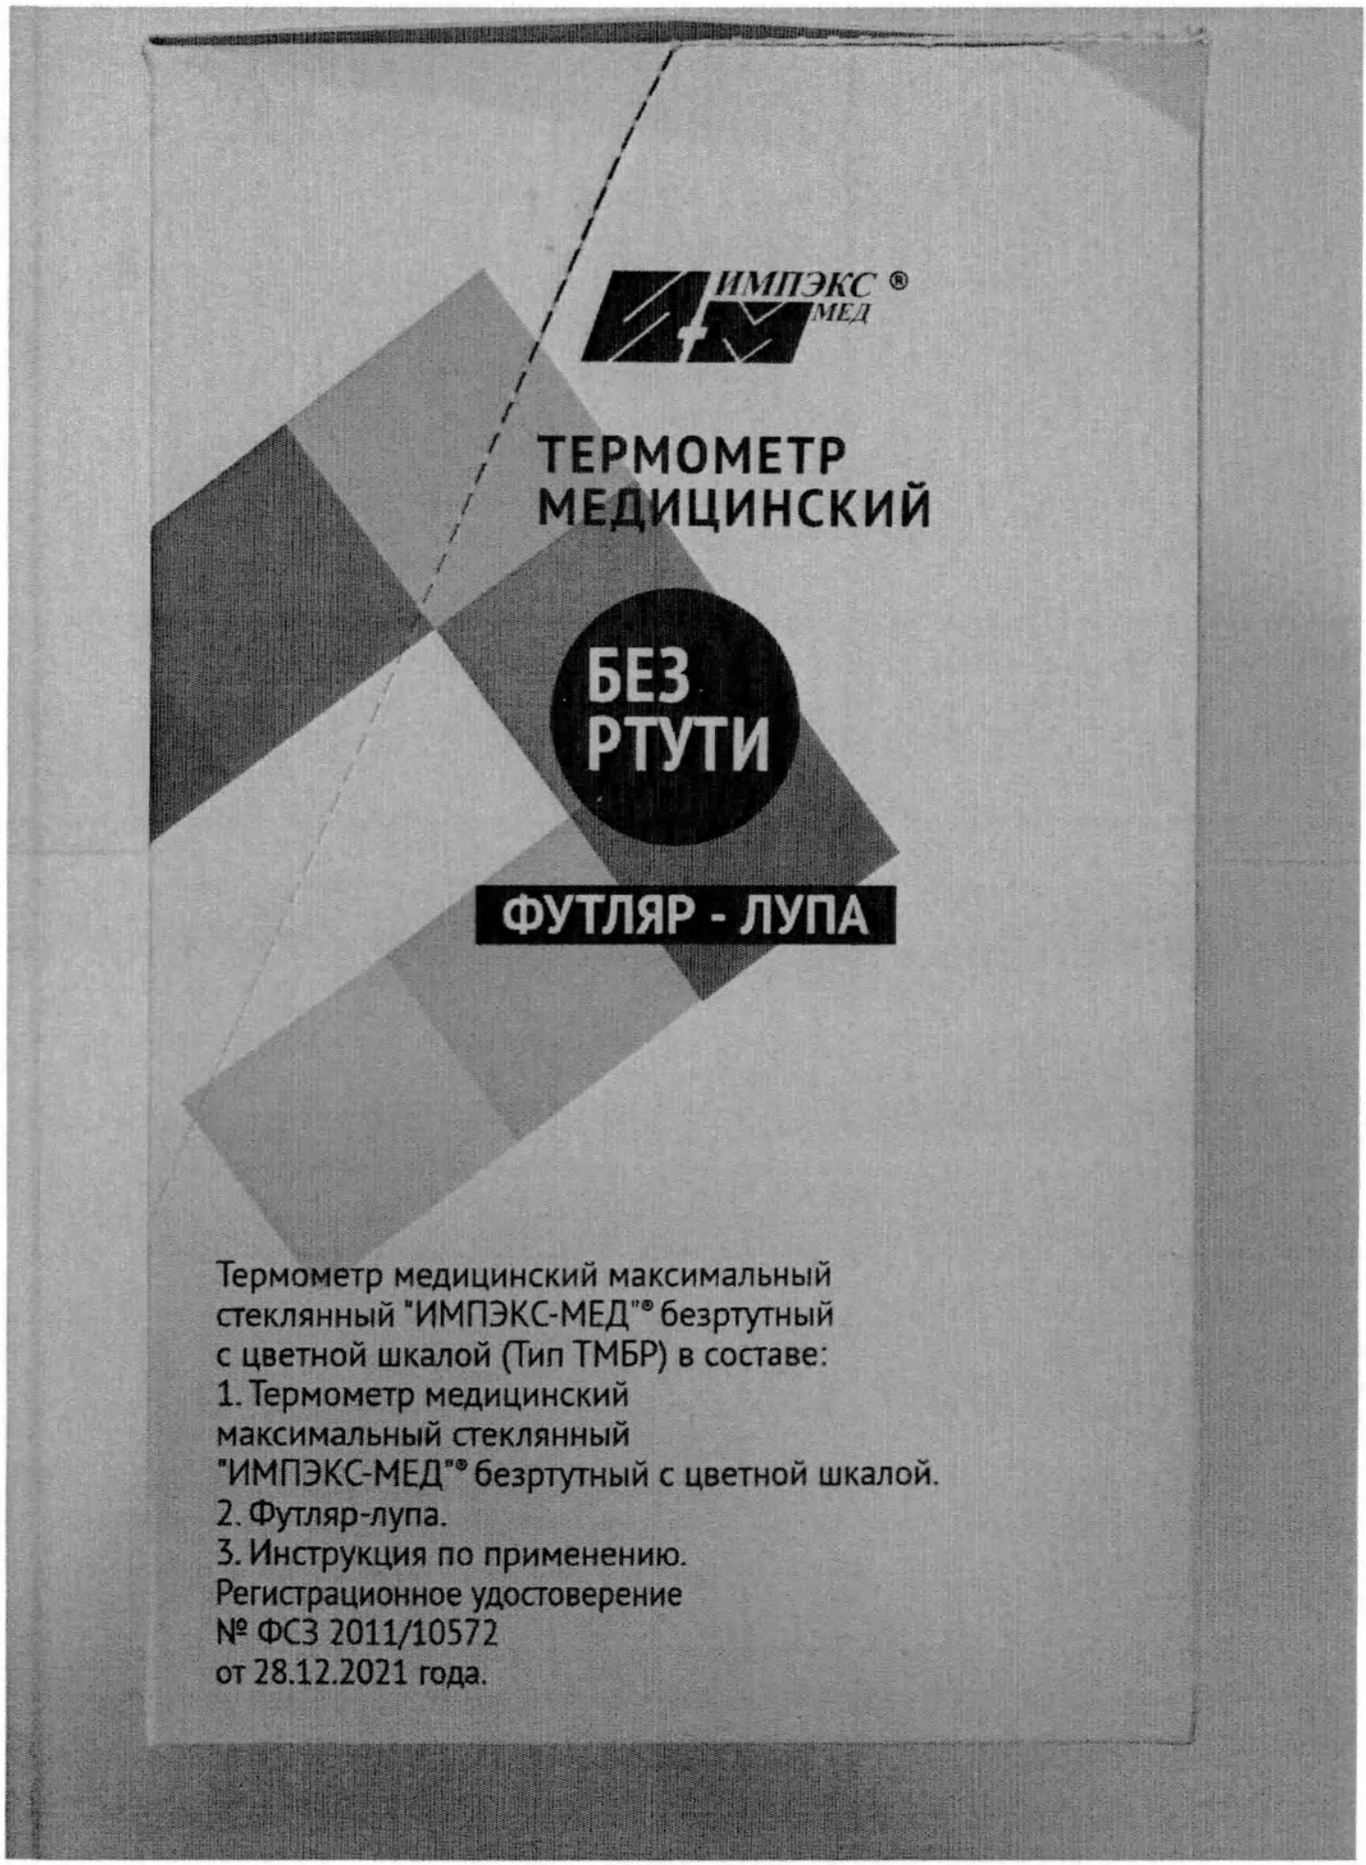

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД ®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

БЕЗ РТУТИ

ФУТЛЯР - ЛУПА

Гарантийный срок эксплуатации -
12 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок хранения -
18 месяцев с даты продажи.

04.2022

LOT 22910

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

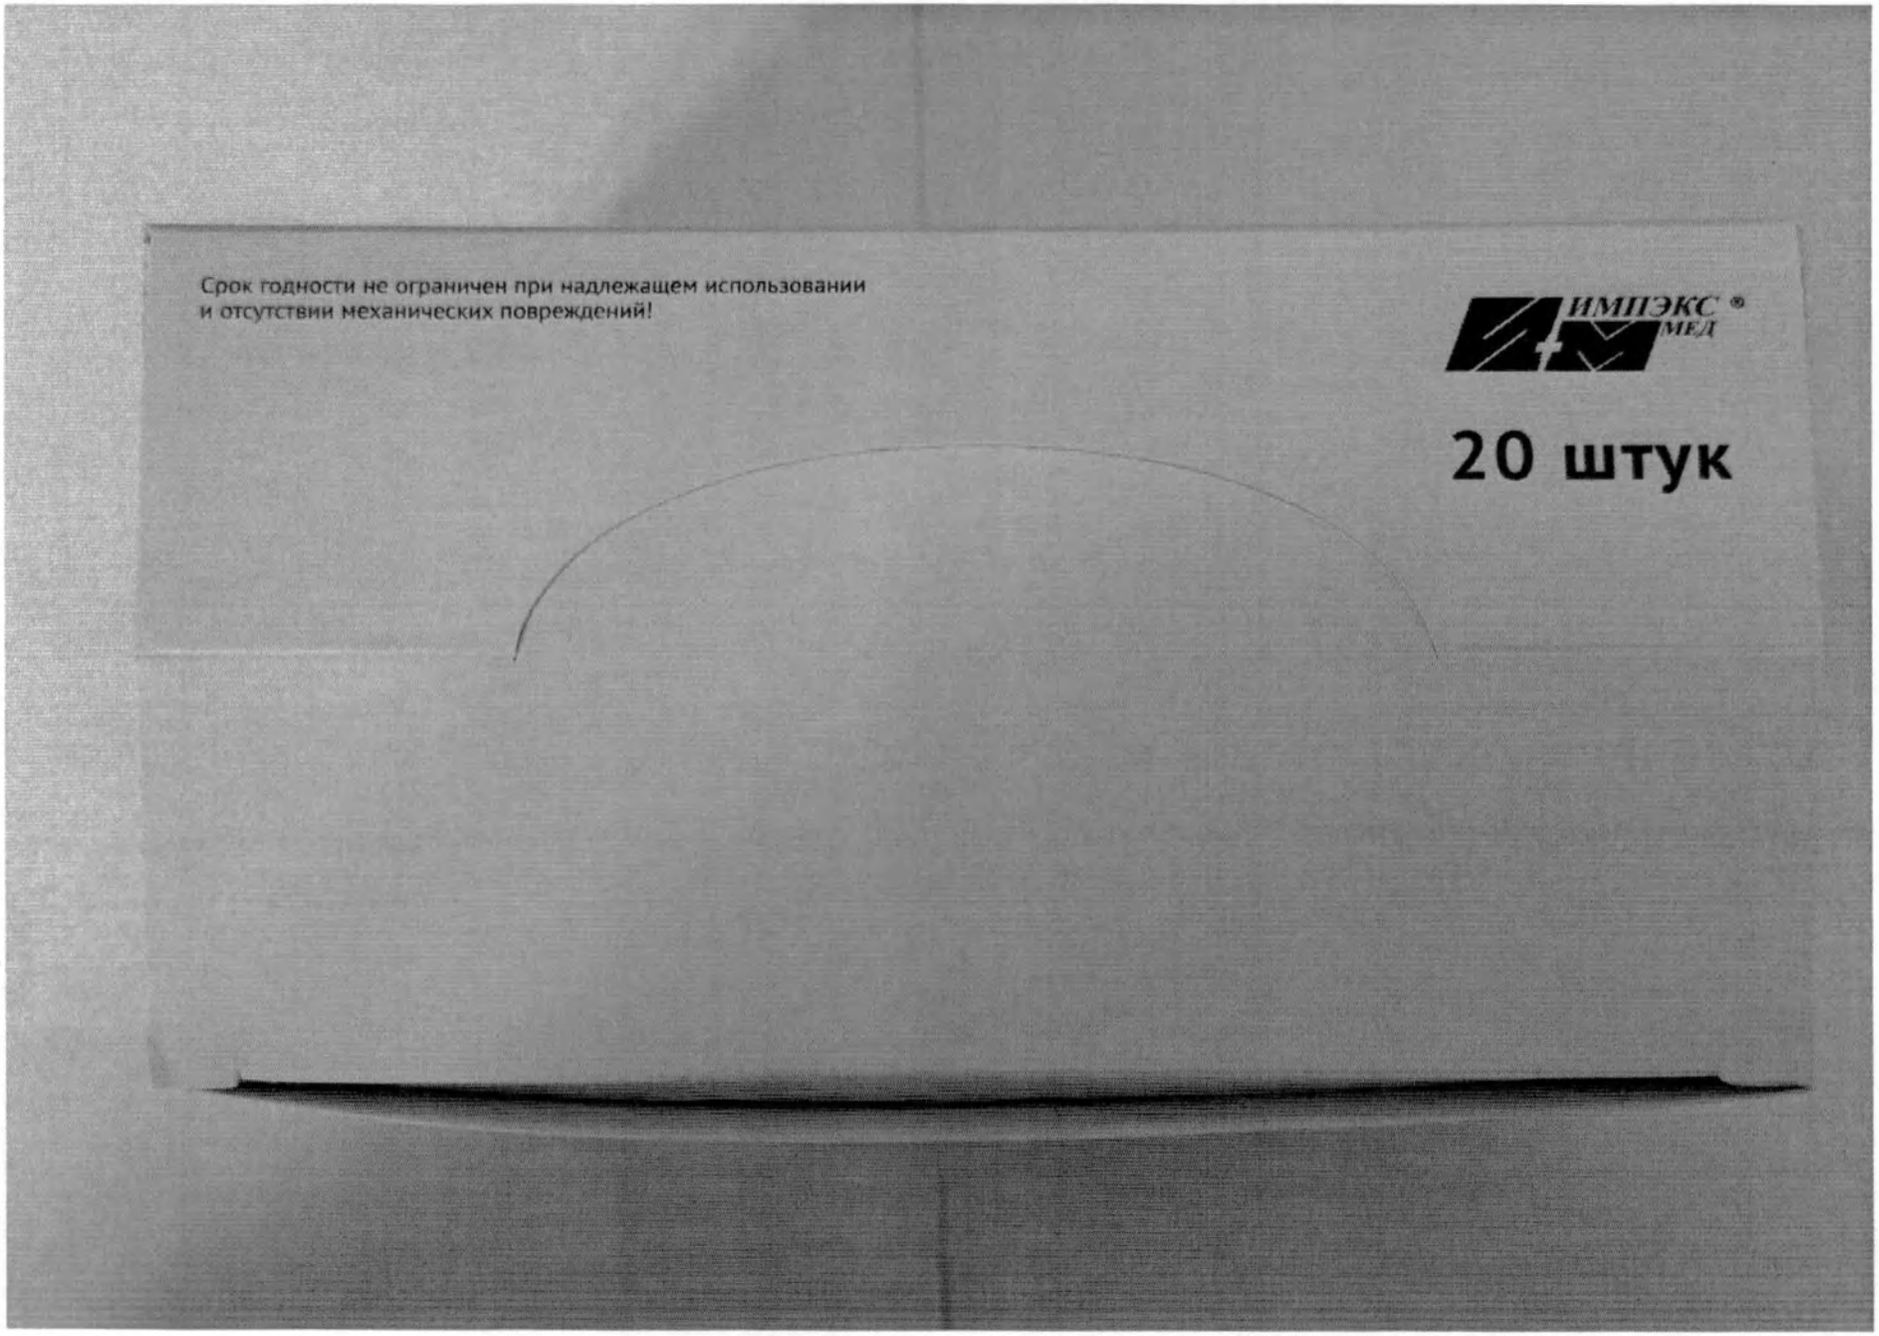

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР) Футляр-люкс.

- индивидуальная упаковка 9W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

НОВИНКА

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМЭЖС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР) в составе:
1. Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМЭЖС-МЕД"® безртутный. 2. Футляр-люкс. 3. Инструкция по применению
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572 от 28.12.2021 года. Бессрочно

Термометр медицинский максимальный стеклянный "ИМЭЖС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой.
Футляр-люкс. Инструкция по применению.

1 ШТУКА

Транспортирование и хранение. Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упаковывают кашки или вложен из гофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить при температуре окружающего воздуха от -5°С до +42°С с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. **Стеклянные!**

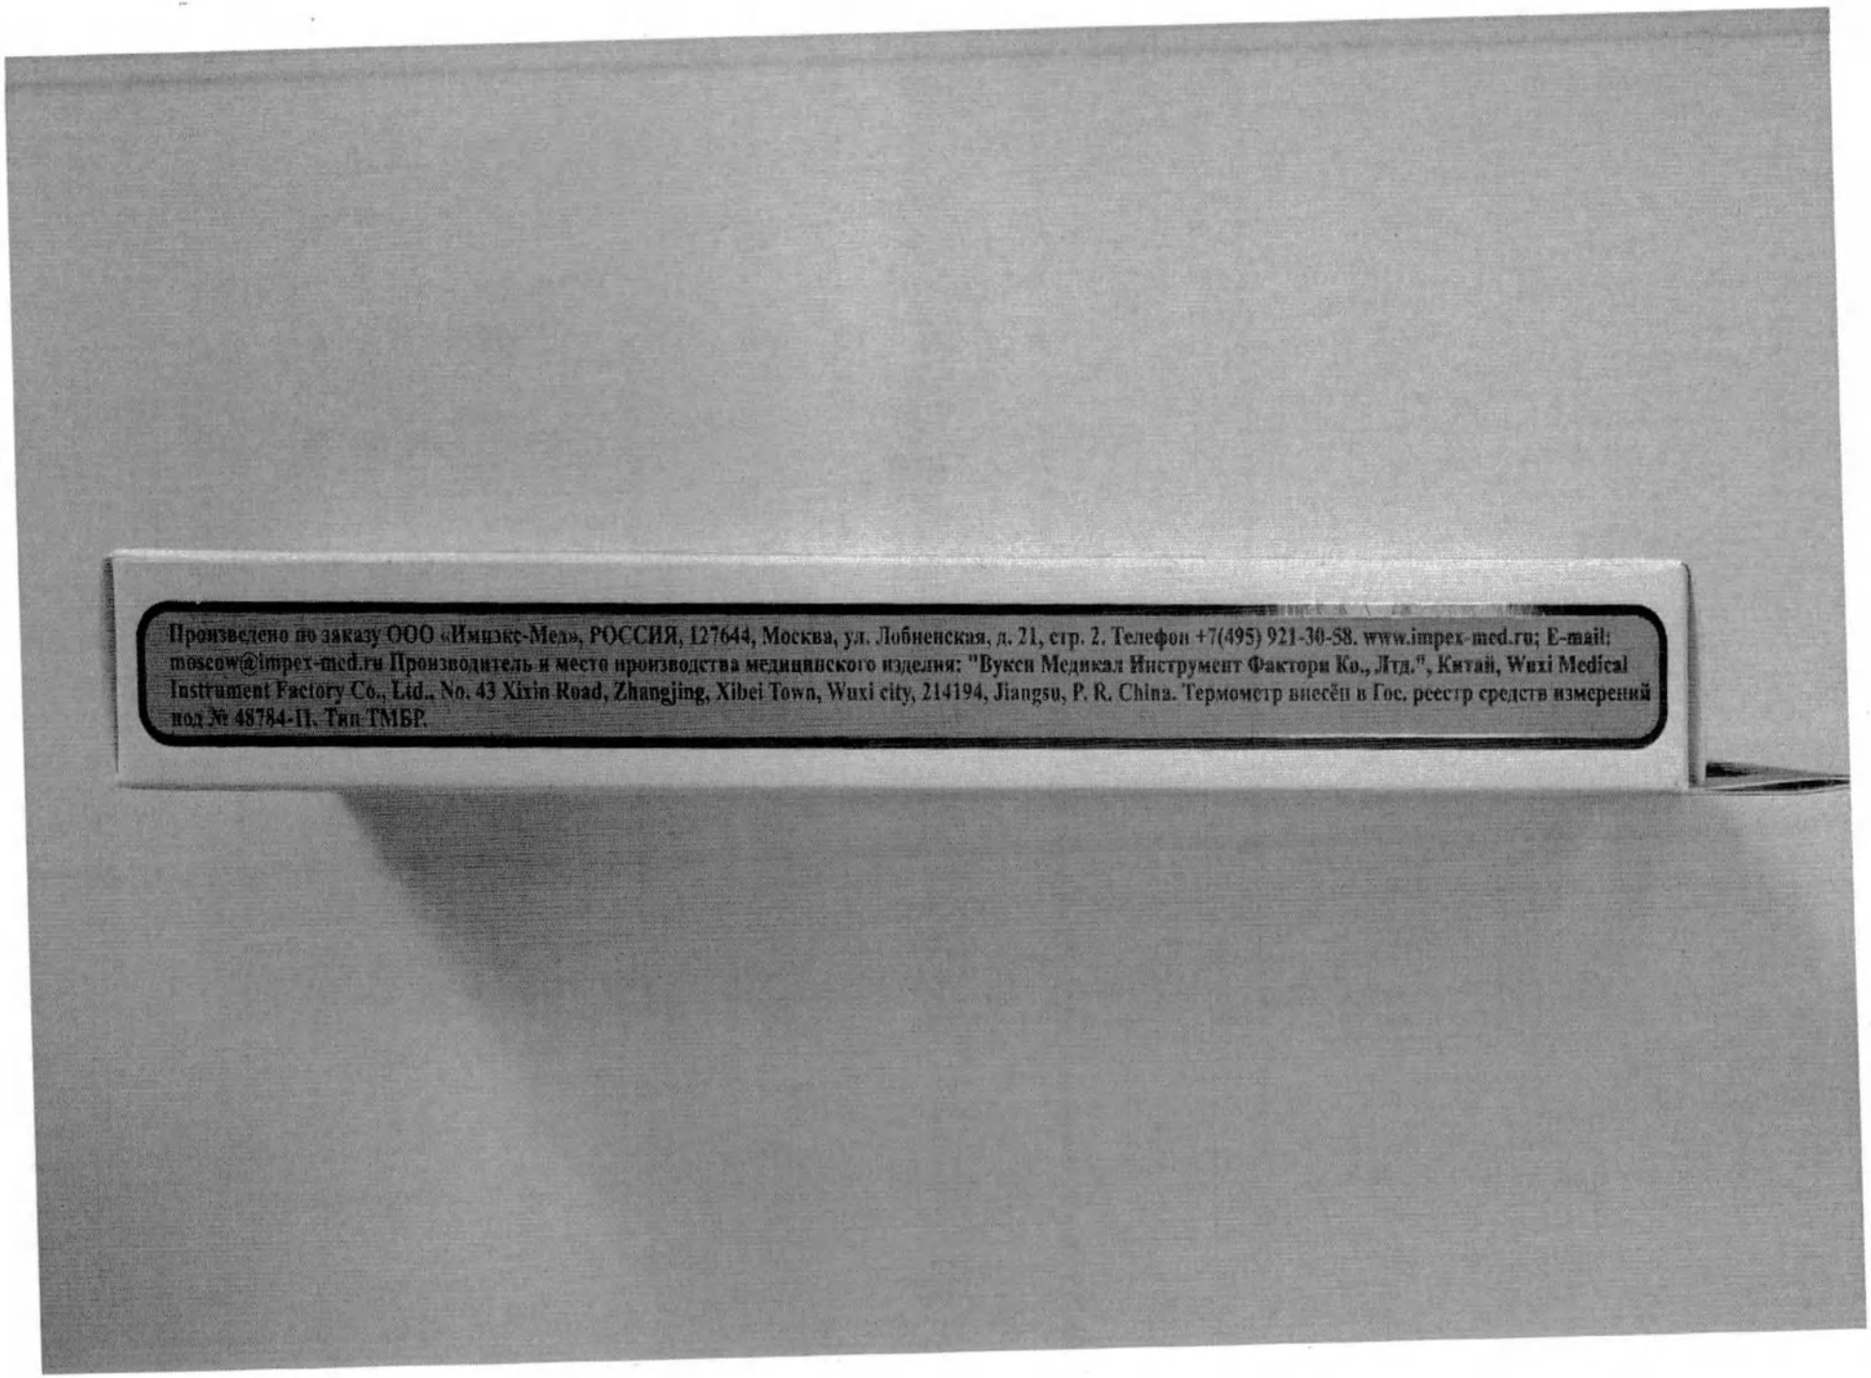

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

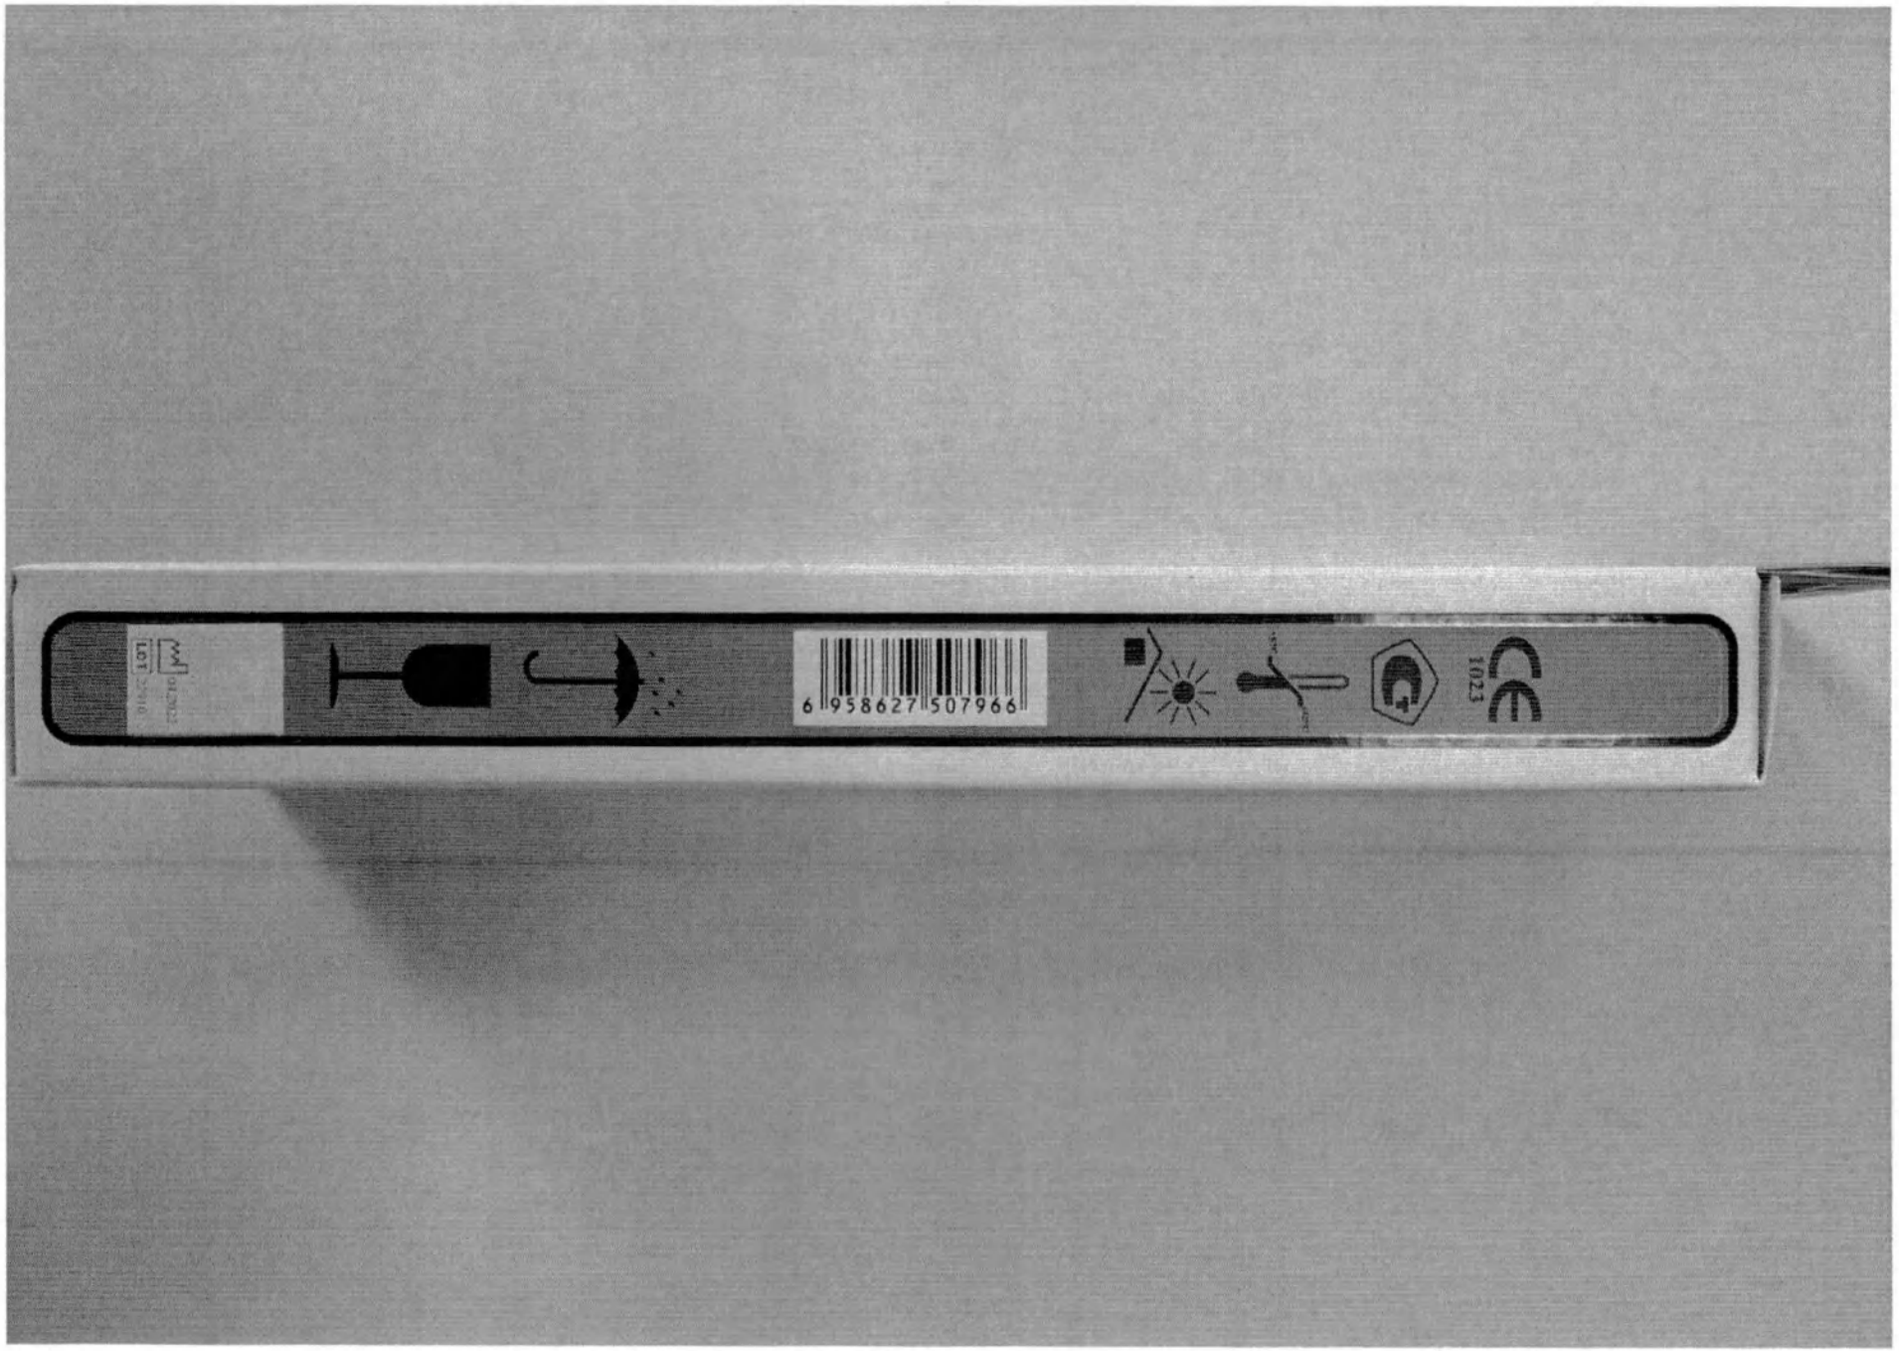

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

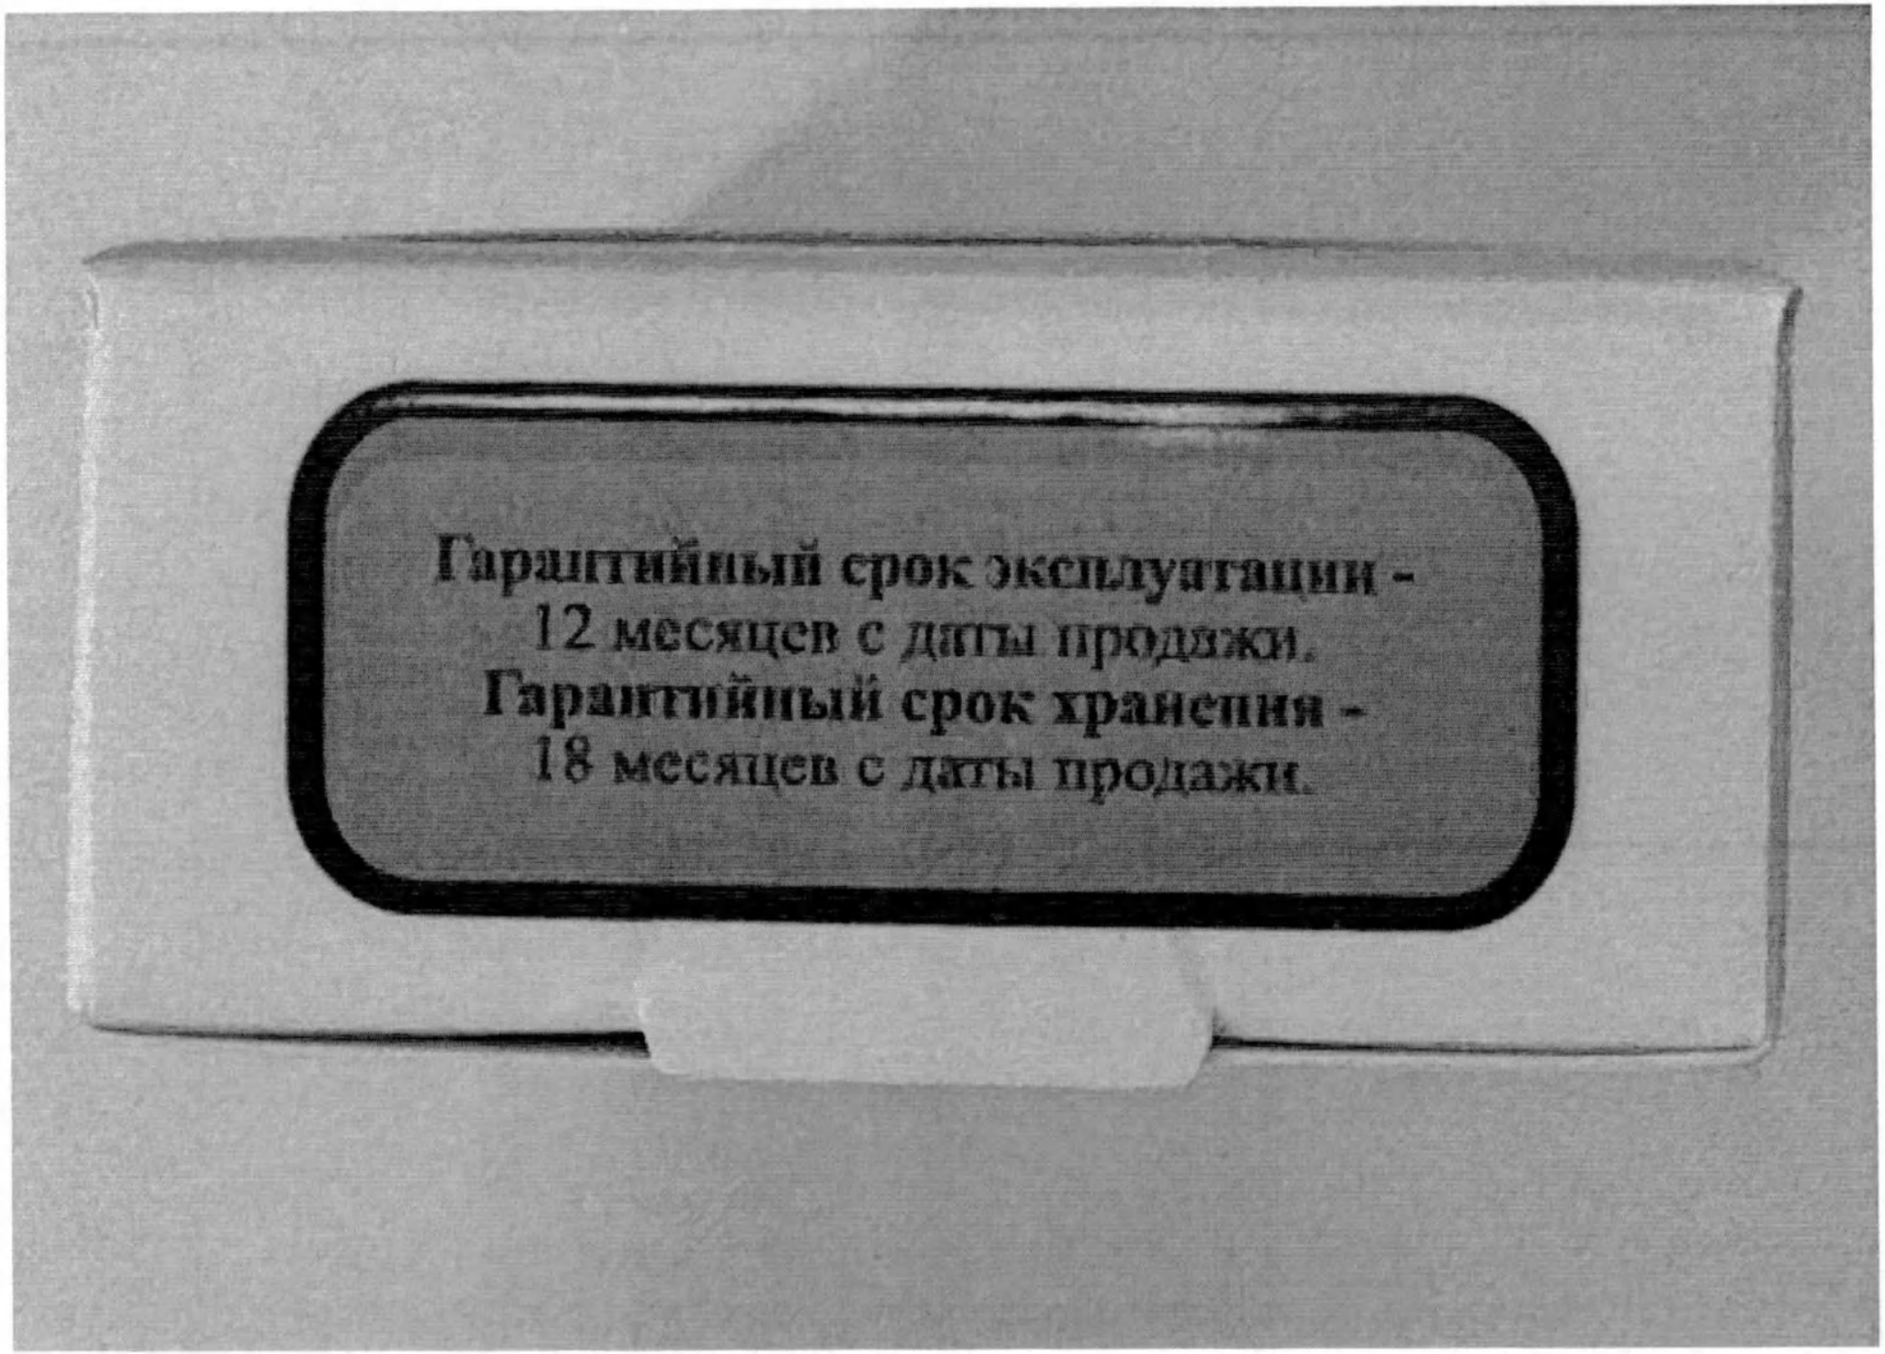

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- групповая упаковка 9W:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР)
в составе: 1. Термометр медицинский максимальный стеклянный
"ИМПЭКС-МЕД"® безртутный. 2. Футляр-люкс.
3. Инструкция по применению.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10572
от 28.12.2021 года. Бессрочно.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД®

Thermometer medical maximum glass "IMPEX-MED"® mercury free with color scale

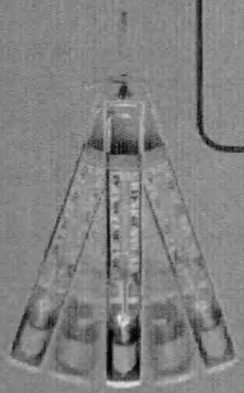

Luxe case.
Instruction for use.

MERCURY FREE

Транспортирование и хранение.

Термометры устойчивы к температурным воздействиям при транспортировании и хранении. При транспортировке термометры упакованы в деревянные ящики или ящики изгофрированного картона или другую тару, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании. Транспортирование термометров может производиться любым видом закрытого транспорта. Термометры следует транспортировать и хранить с предохранением от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре внешней среды от +5°С до +42°С. Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты продажи.

Осторожно стекло!

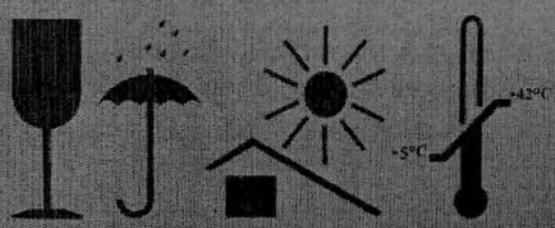

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИМПЭКС МЕД®

6 958627 507966

04.2022

LOT 22910

ТЕРМОМЕТР БЕЗ РТУТИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

109 листов

Генеральный директор
ООО "Шинэс-Мед"
Иванов И.И.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Импэкс-Мед»
_____ Холодкова В.И.
« » _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»®

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный (Тип ТМБР)

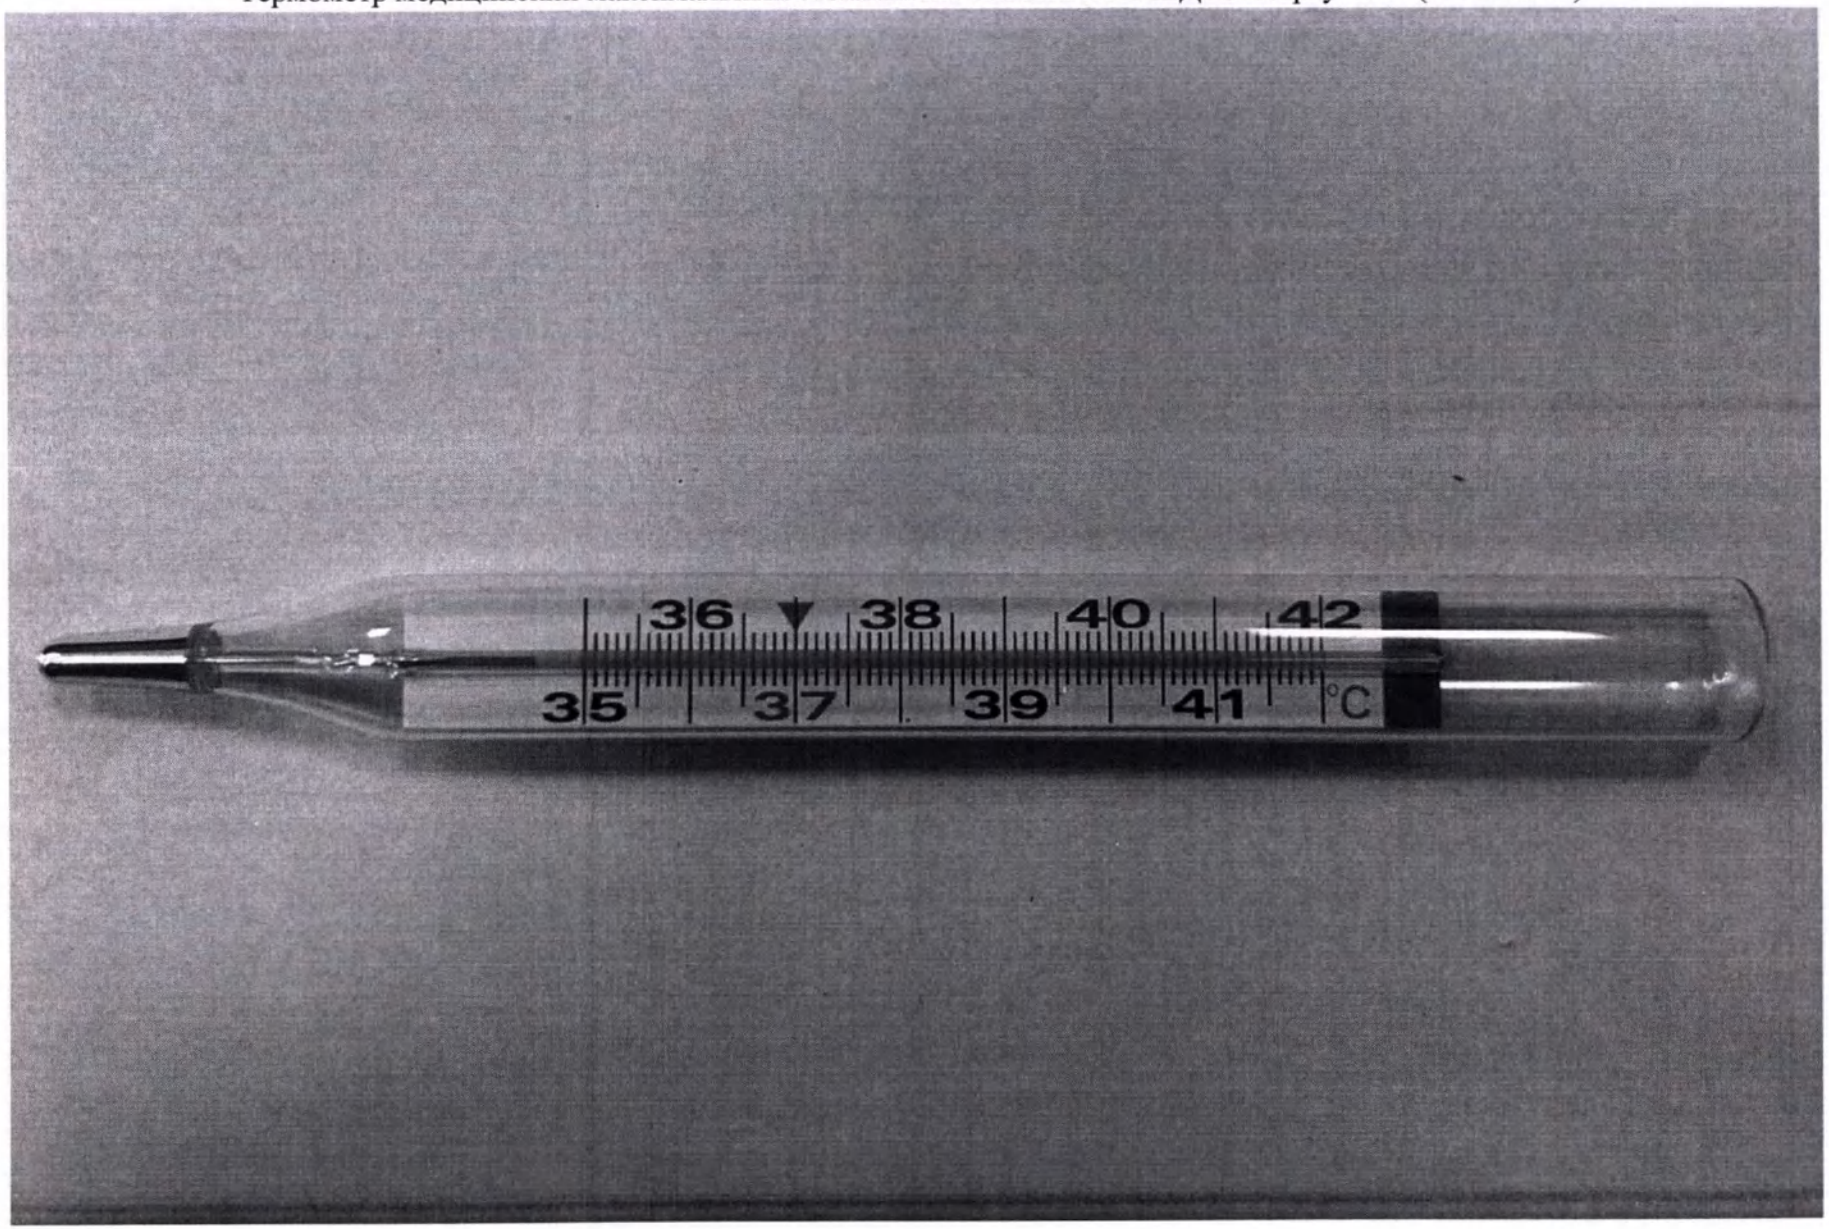

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»® безртутный с цветной шкалой (Тип ТМБР)

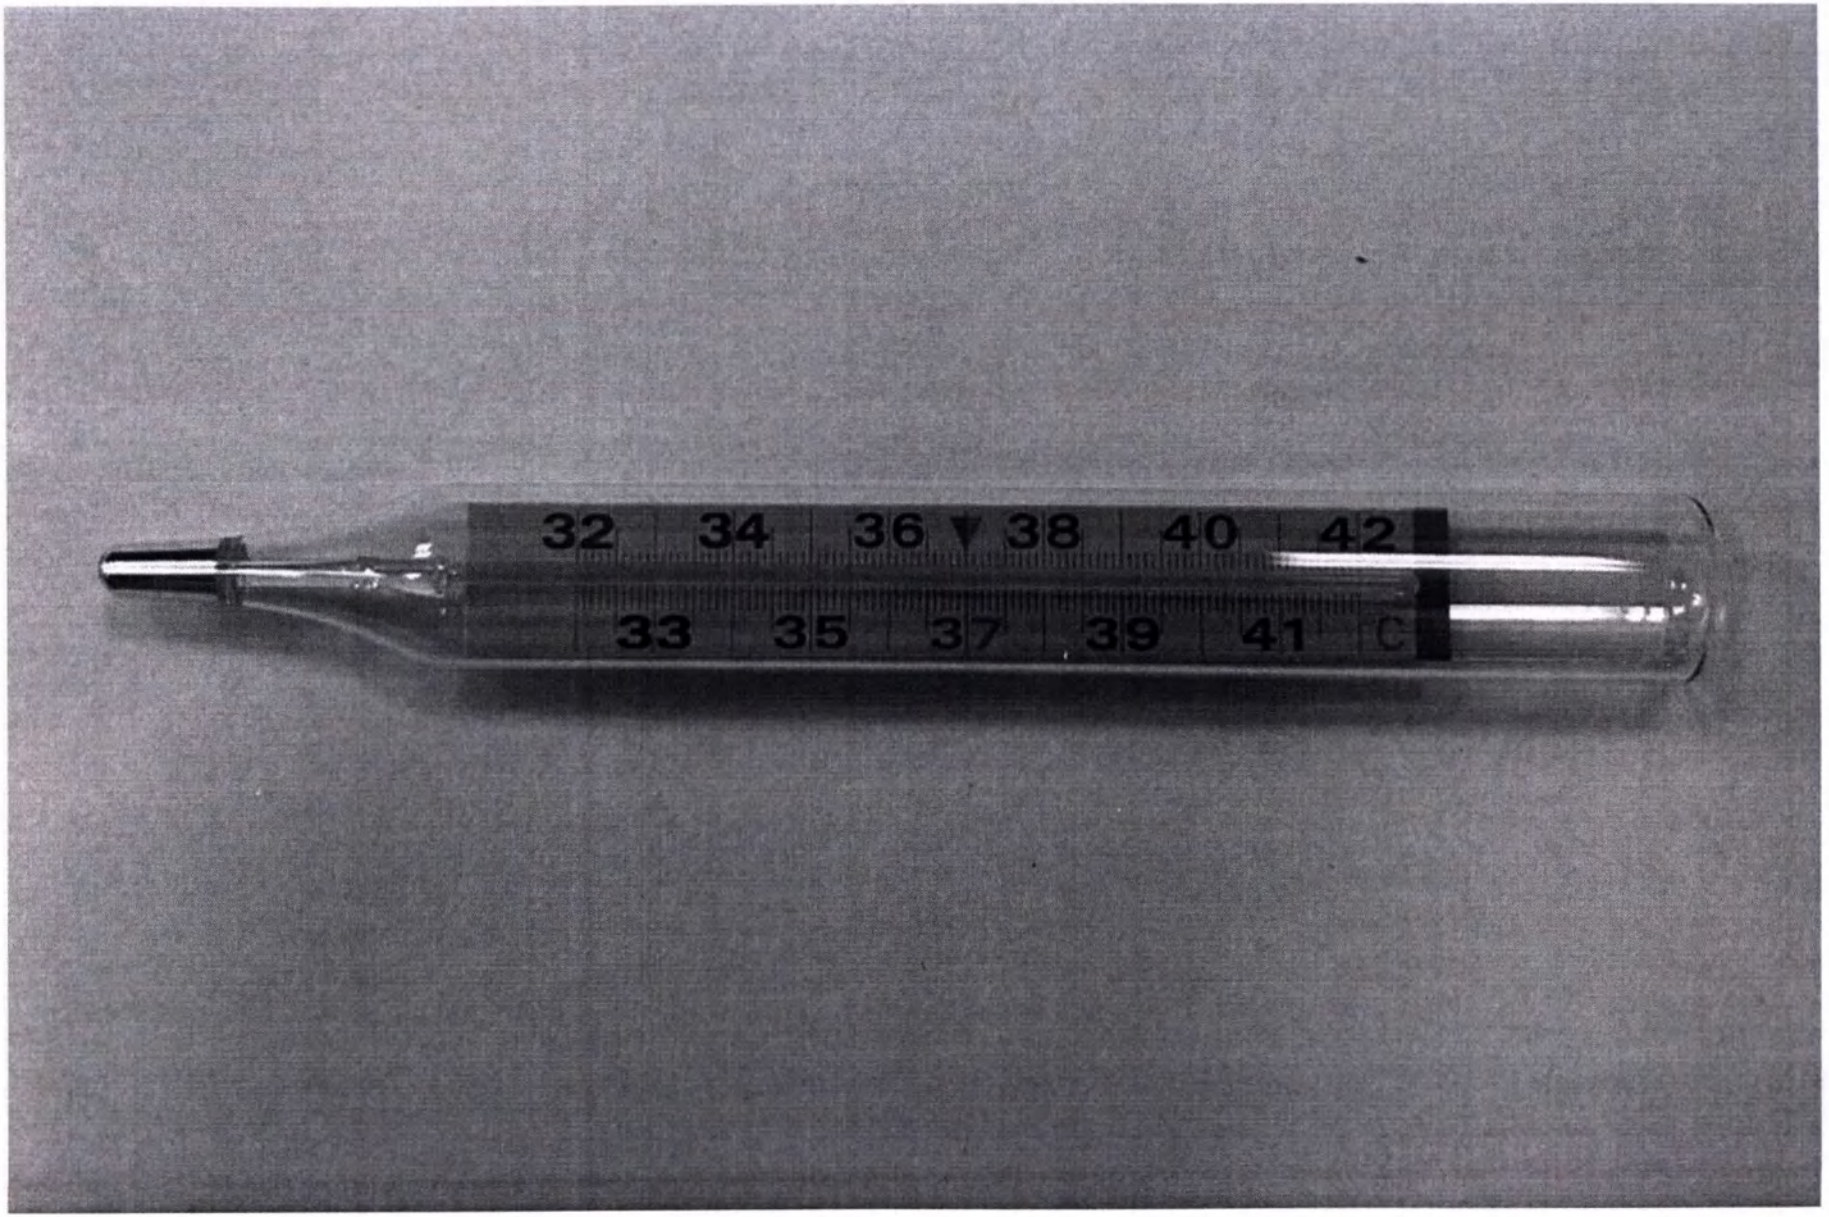

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Футляр классический

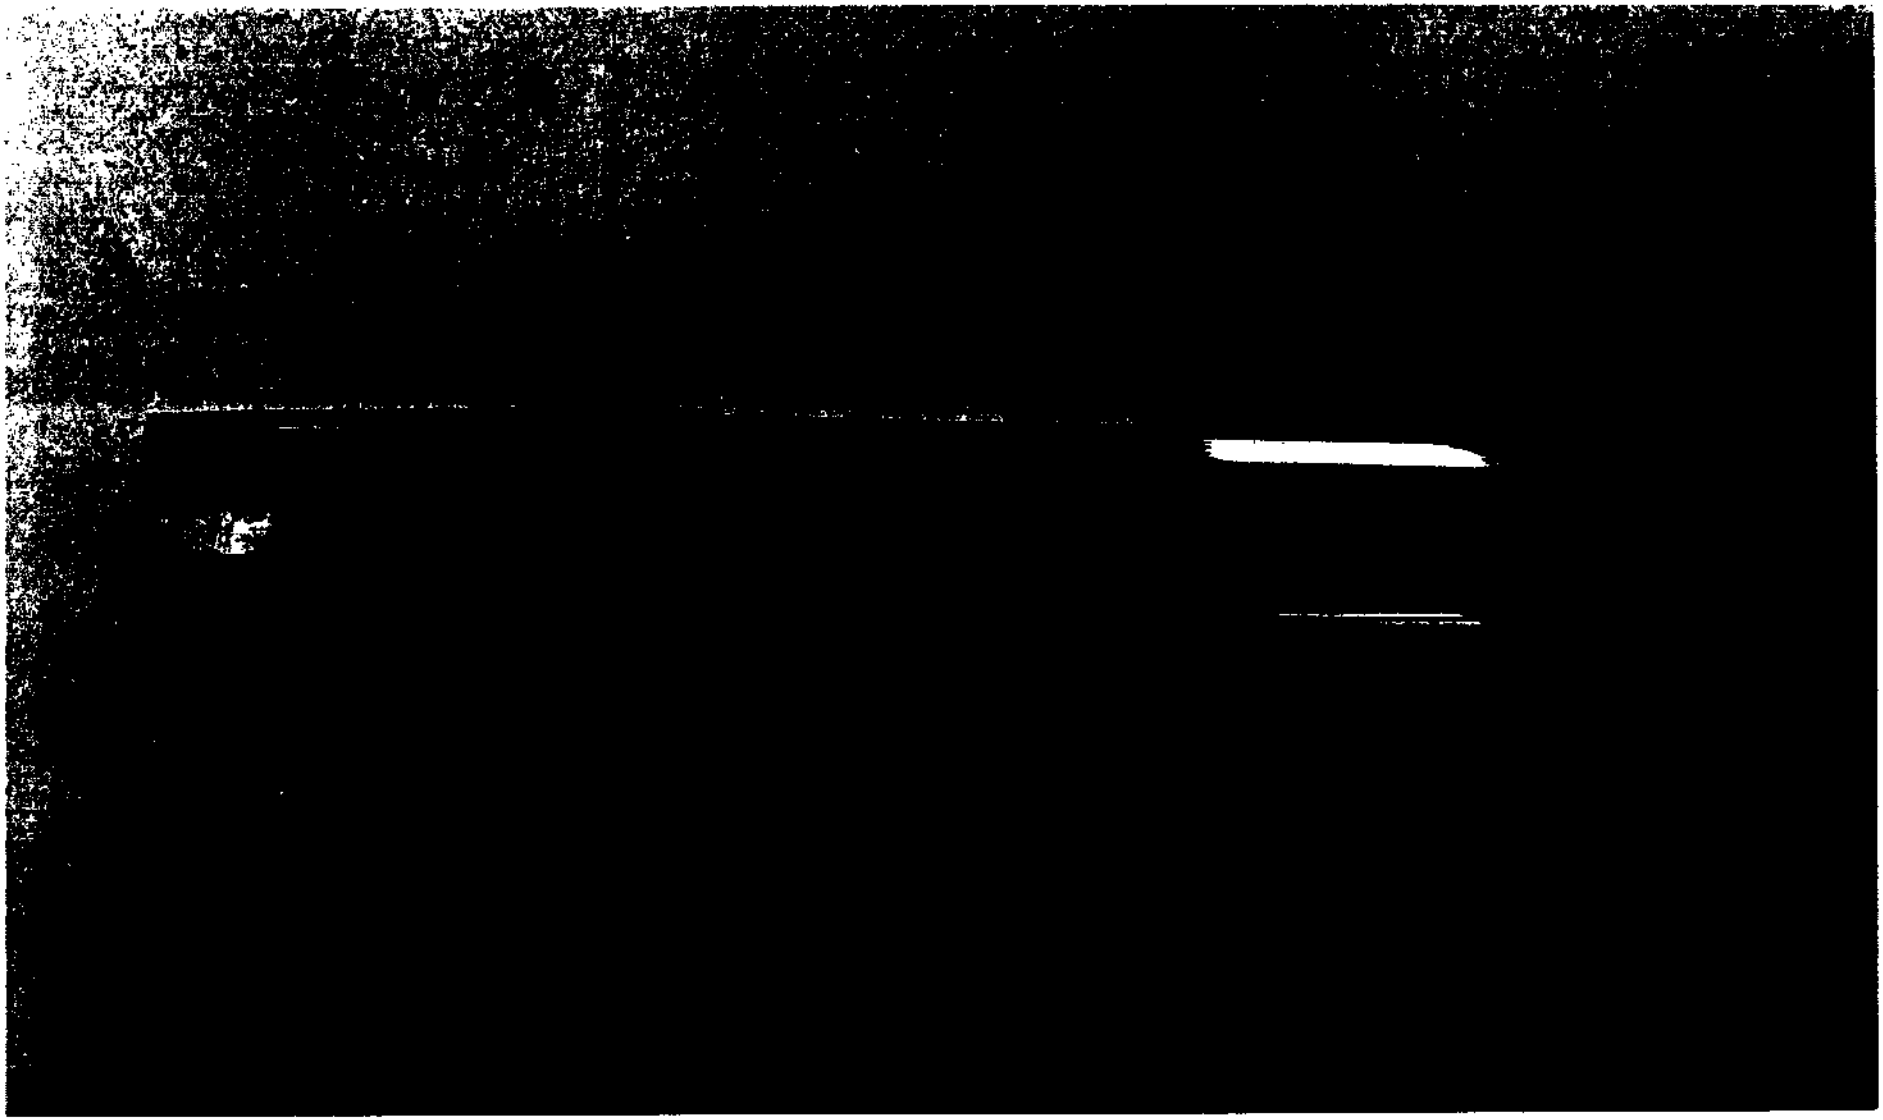

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Футляр для легкого встряхивания

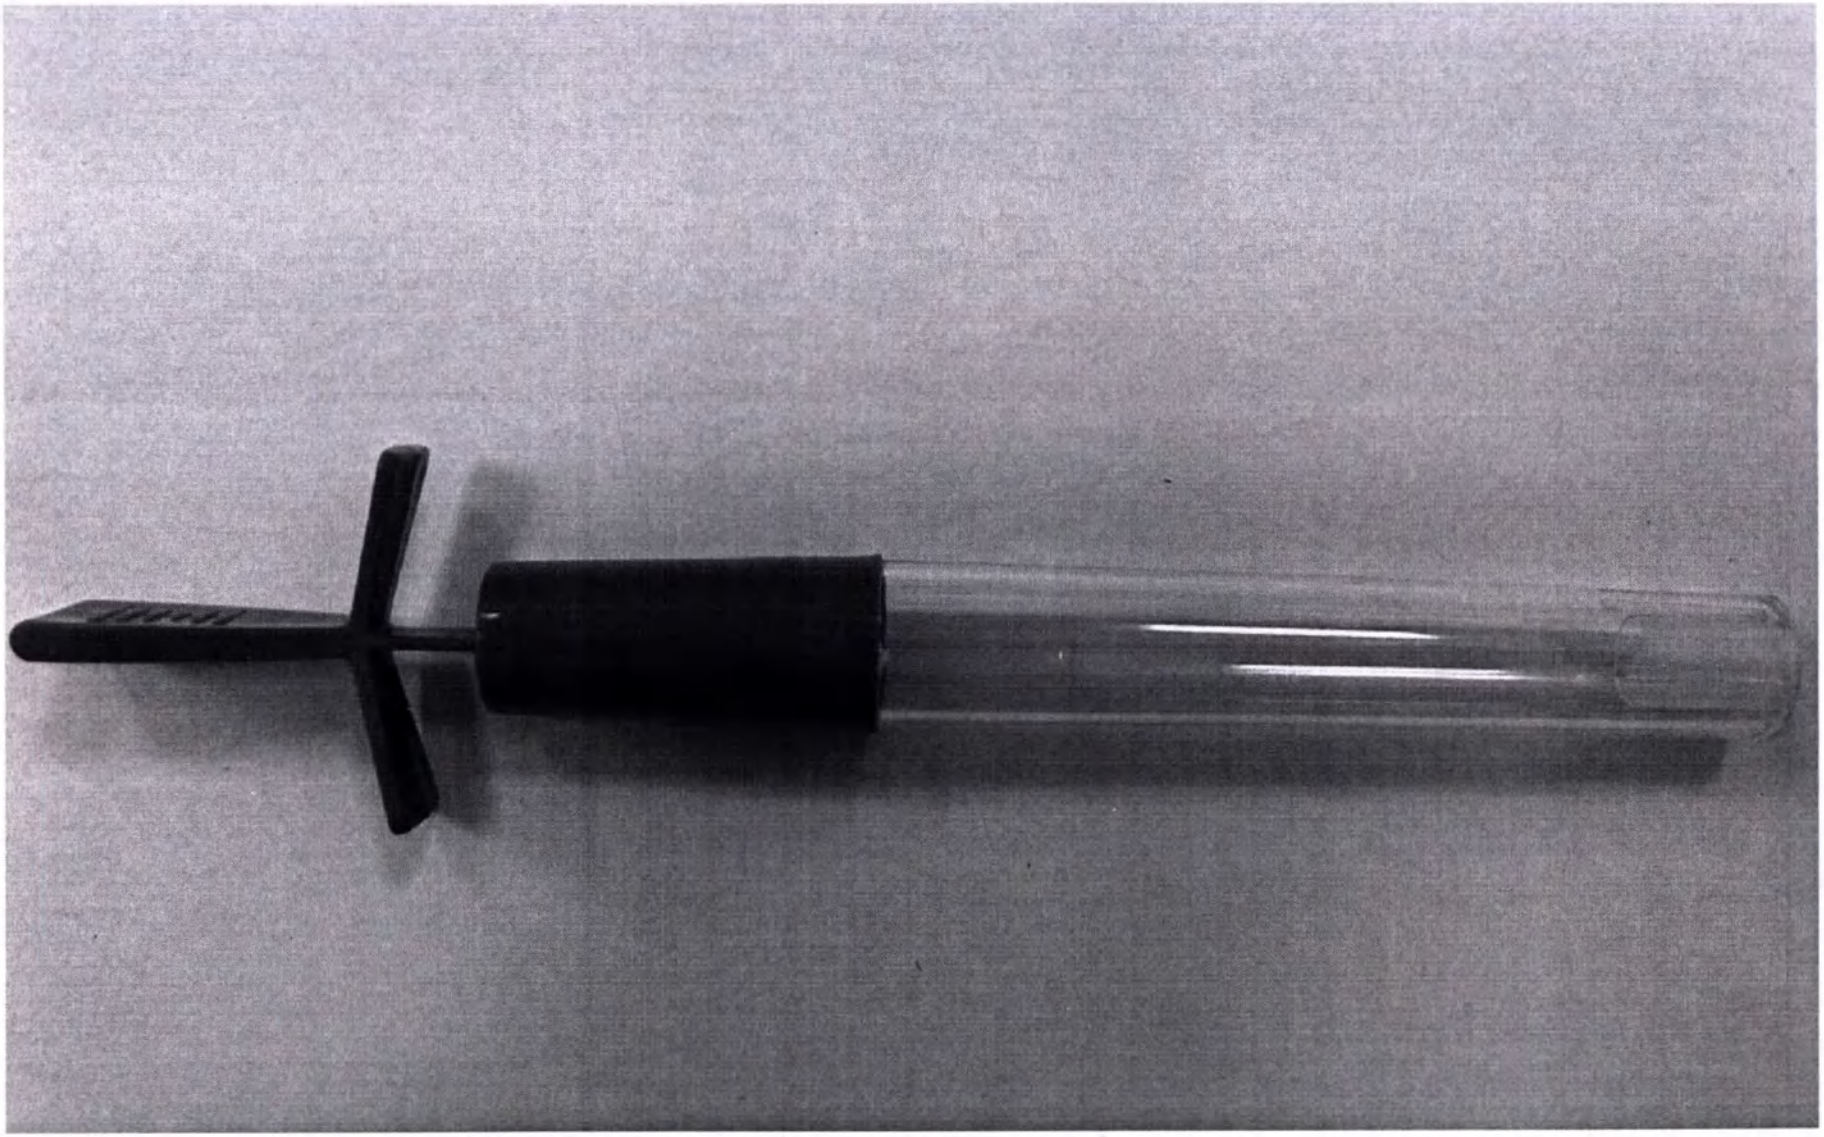

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Футляр - лупа

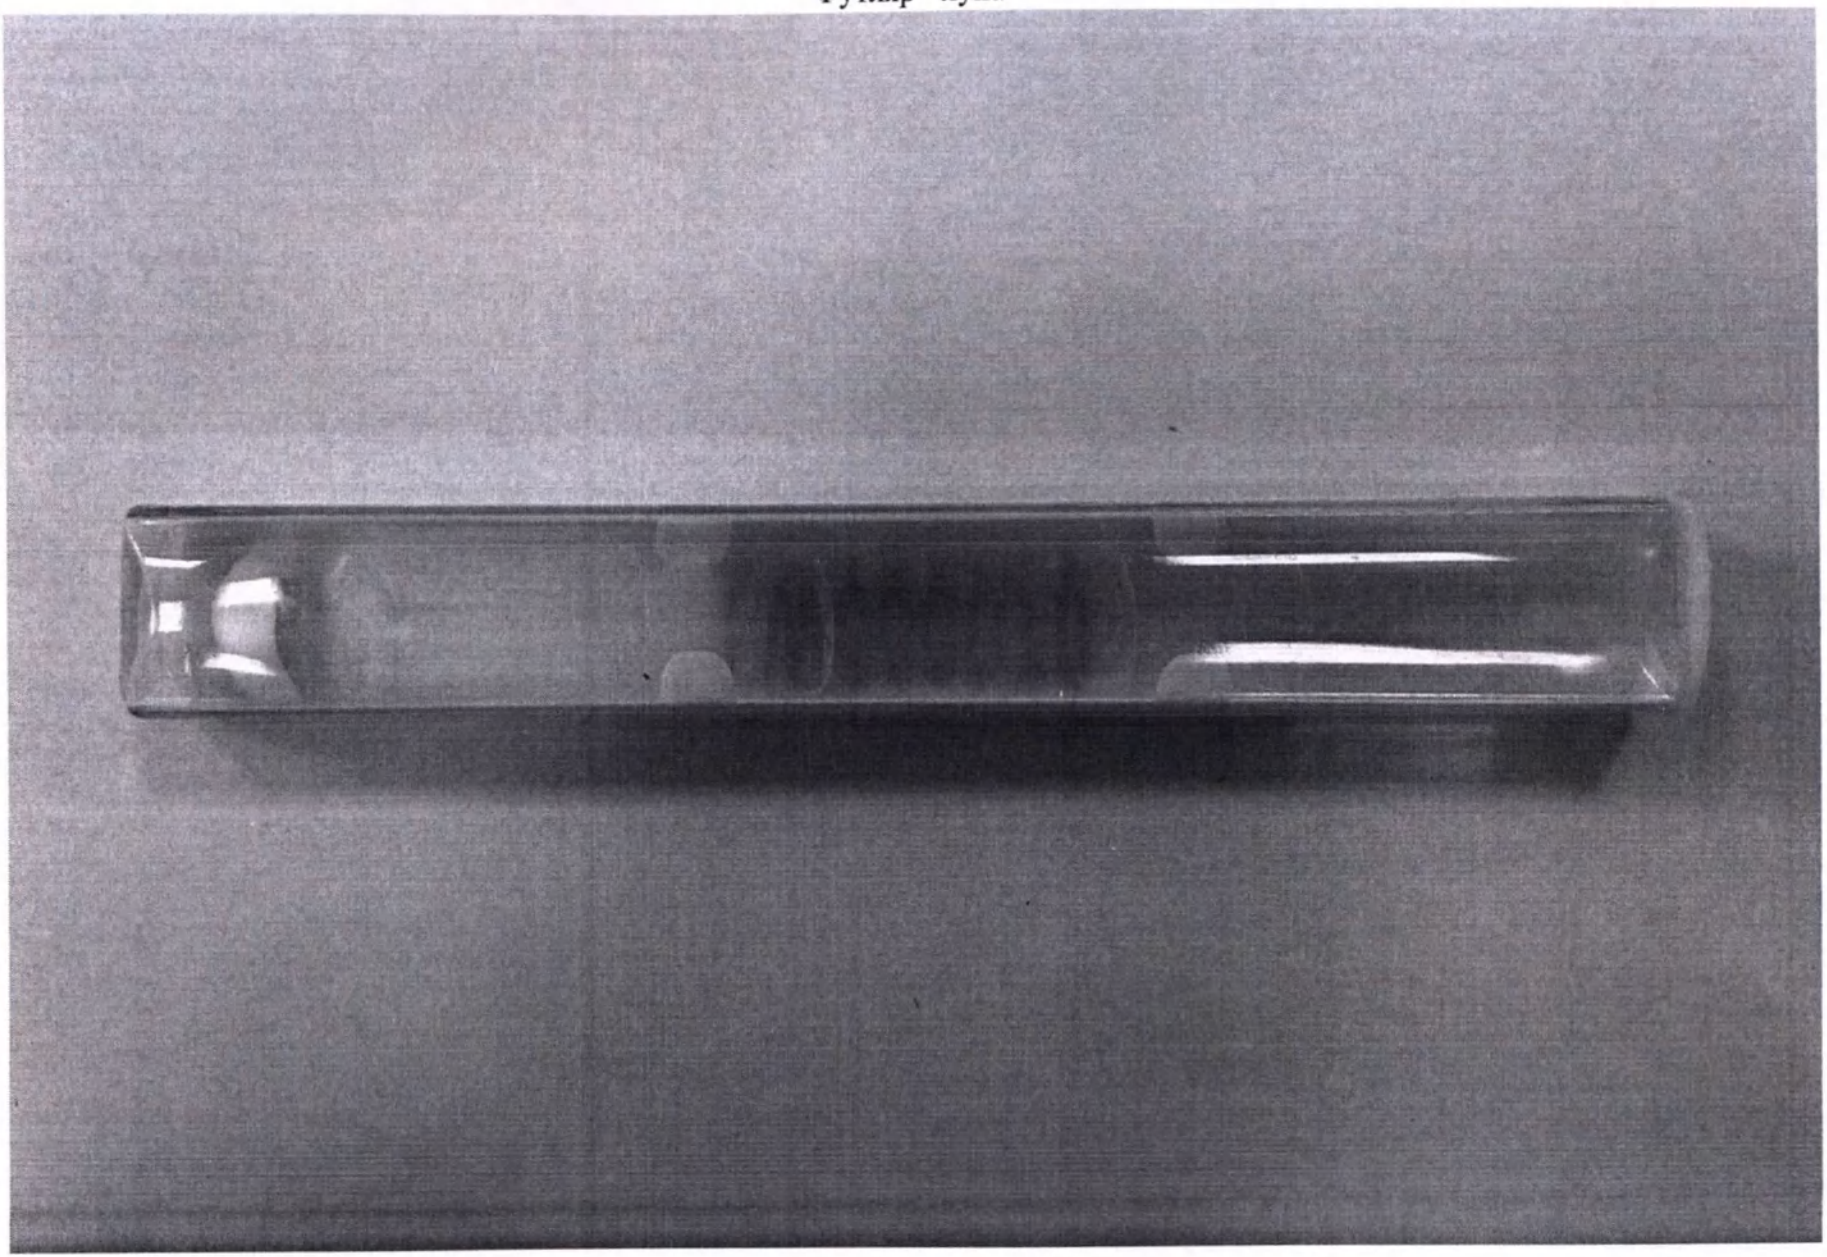

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Футляр - люкс

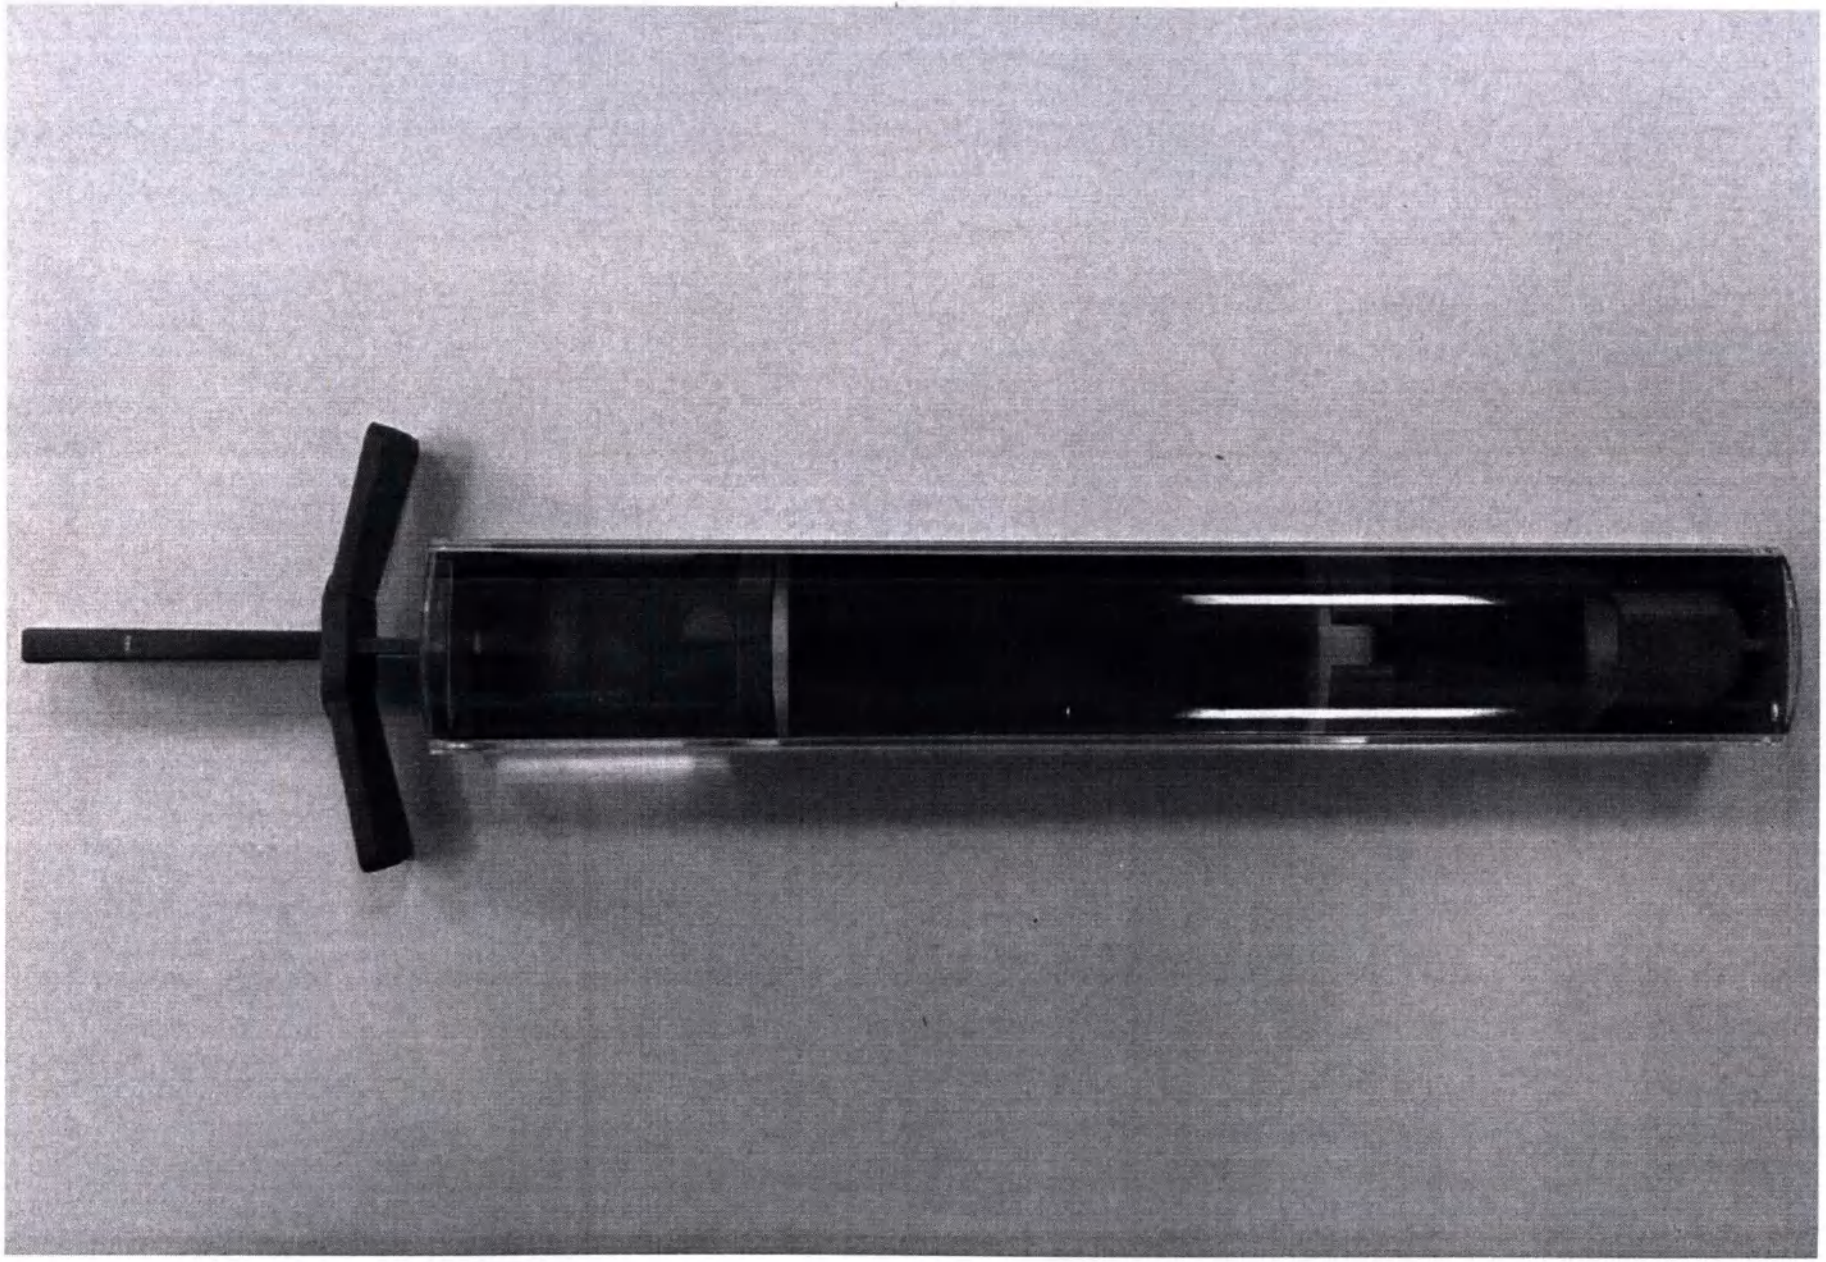

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU