

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз» Е.К. Ефремова
«06» 09 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Раствор очищающий для анализатора автоматического
гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024



<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл> - Ферментативный очиститель концентрат в упаковке

«Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл» - макет маркировки



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагентов после
вскрытия упаковки 90 дней.



ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ (ЭНЗИМАТИК КОНЦЕНТРАТ), 50 мл

Раствор очищающий для анализатора автоматического
гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и используйте в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России. www.kdsreagents.ru
Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новоорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



XXXXXX



XX.XX.XXXX

50 мл



XXXXXX



XX.XX.XXXX

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению



<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл> - Раствор очищающий, 50 мл в упаковке

<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл> - макет маркировки



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагентов после
вскрытия упаковки 90 дней.



РАСТВОР ОЧИЩАЮЩИЙ, 50 мл

Раствор очищающий для анализатора
автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и используйте в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России. www.kdsreagents.ru
Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новоорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



XXXXXX



XXXXXX



XX.XX.XXXX

50 мл



XX.XX.XXXX

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению





<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 500 мл> - Раствор очищающий, 500 мл в упаковке

«Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 500 мл» - макет маркировки



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагентов после
вскрытия упаковки 90 дней.



РАСТВОР ОЧИЩАЮЩИЙ, 500 мл

Раствор очищающий для анализатора
автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и используйте в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России. www.kdsreagents.ru

Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностика Солюшнз»

Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



XXXXXX



XX.XX.XXXX

500 мл



XXXXXX



XX.XX.XXXX

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению.





<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 500 мл> - маркировка групповой упаковки.



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

+4°C — +35°C

Хранить при температуре +4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия солнечного света.

Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для использования после заморозки.

Срок годности реагентов после вскрытия упаковки 90 дней.

КЭТ

РАСТВОР ОЧИЩАЮЩИЙ, 500 мл

Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению.



1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и используйте в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России. www.kdsreagents.ru
Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностика Соловцов»
Адрес изготовителя: 119333 Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



REF 504-199R



23.11.2023

500 мл



LOT 2208014-16




23.11.2025

500 мл x 12 шт Вес брутто 7,3 кг

<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 500 мл> - маркировка групповой упаковки.



<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 500 мл> - групповая упаковка.



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по
применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

+4°C — +35°C
Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать
воздействия
солнечного света.

Срок годности 24 месяца.
Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.
Реагент не пригоден для
использования после
заморозки.
Срок годности реагентов
после вскрытия упаковки
90 дней.



РАСТВОР ОЧИЩАЮЩИЙ, 50 мл

Раствор для очистки анализатора
автоматического гематологического по
ТУ 20.59.52-006-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и используйте в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России, www.kzevarients.ru
Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностика Солнечная»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новороссийская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



504-136R



08.09.2023



2208014-08



08.09.2025

Регистрационное
удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента
качества применительно
к производству и
реализации изделий
медицинского
назначения
соответствует стандарту
ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:
См. инструкцию по
применению



50 мл

50 мл x 80 шт
Вес брутто 5 кг

«Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл» - маркировка групповой упаковки.



<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл> или <Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл> - маркировка групповой упаковки.



<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл> или <Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл> - групповая упаковка.



<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл> или <Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл> - групповая упаковка.




<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Раствор очищающий, 50 мл> или <Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл> - групповая упаковка.



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по
применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °С в сухом месте.

Не допускать
воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.
Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.
Реагент не пригоден для
использования после
заморозки.
Срок годности реагентов
после вскрытия упаковки
90 дней.



**ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ
(ЭНЗИМАТИК КОНЦЕНТРАТ), 50 мл**

Раствор очищающий для анализатора
автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и используйте в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России. www.kdsreagents.ru
Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностика Солюшнз»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новоорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



504-198R



09.10.2023



50 мл



2210026-01




09.10.2025

50 мл x 80 шт
Вес брутто 5 кг

<Раствор очищающий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-006-85747522-2024. Вариант исполнения: Ферментативный очиститель концентрат (Энзиматик концентрат), 50 мл> - маркировка групповой упаковки.

Сброшюровано и прошито 16 листов
« 6 » 09 2024 г.

Генеральный директор
ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»

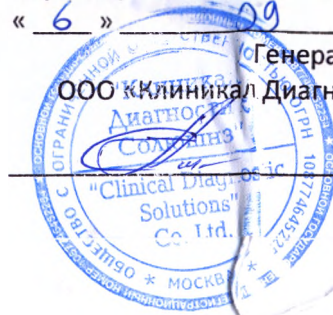

Е.А. Ефремова