

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ
ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ
ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7,
стр. 4
Адрес

Генеральный директор
Должность

Мартин Пьер Колас

Фамилия, Имя



16.08.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature

Фотографические изображения

Бронхоскоп жесткий миниатюрный, в вариантах исполнения, с принадлежностями

2024

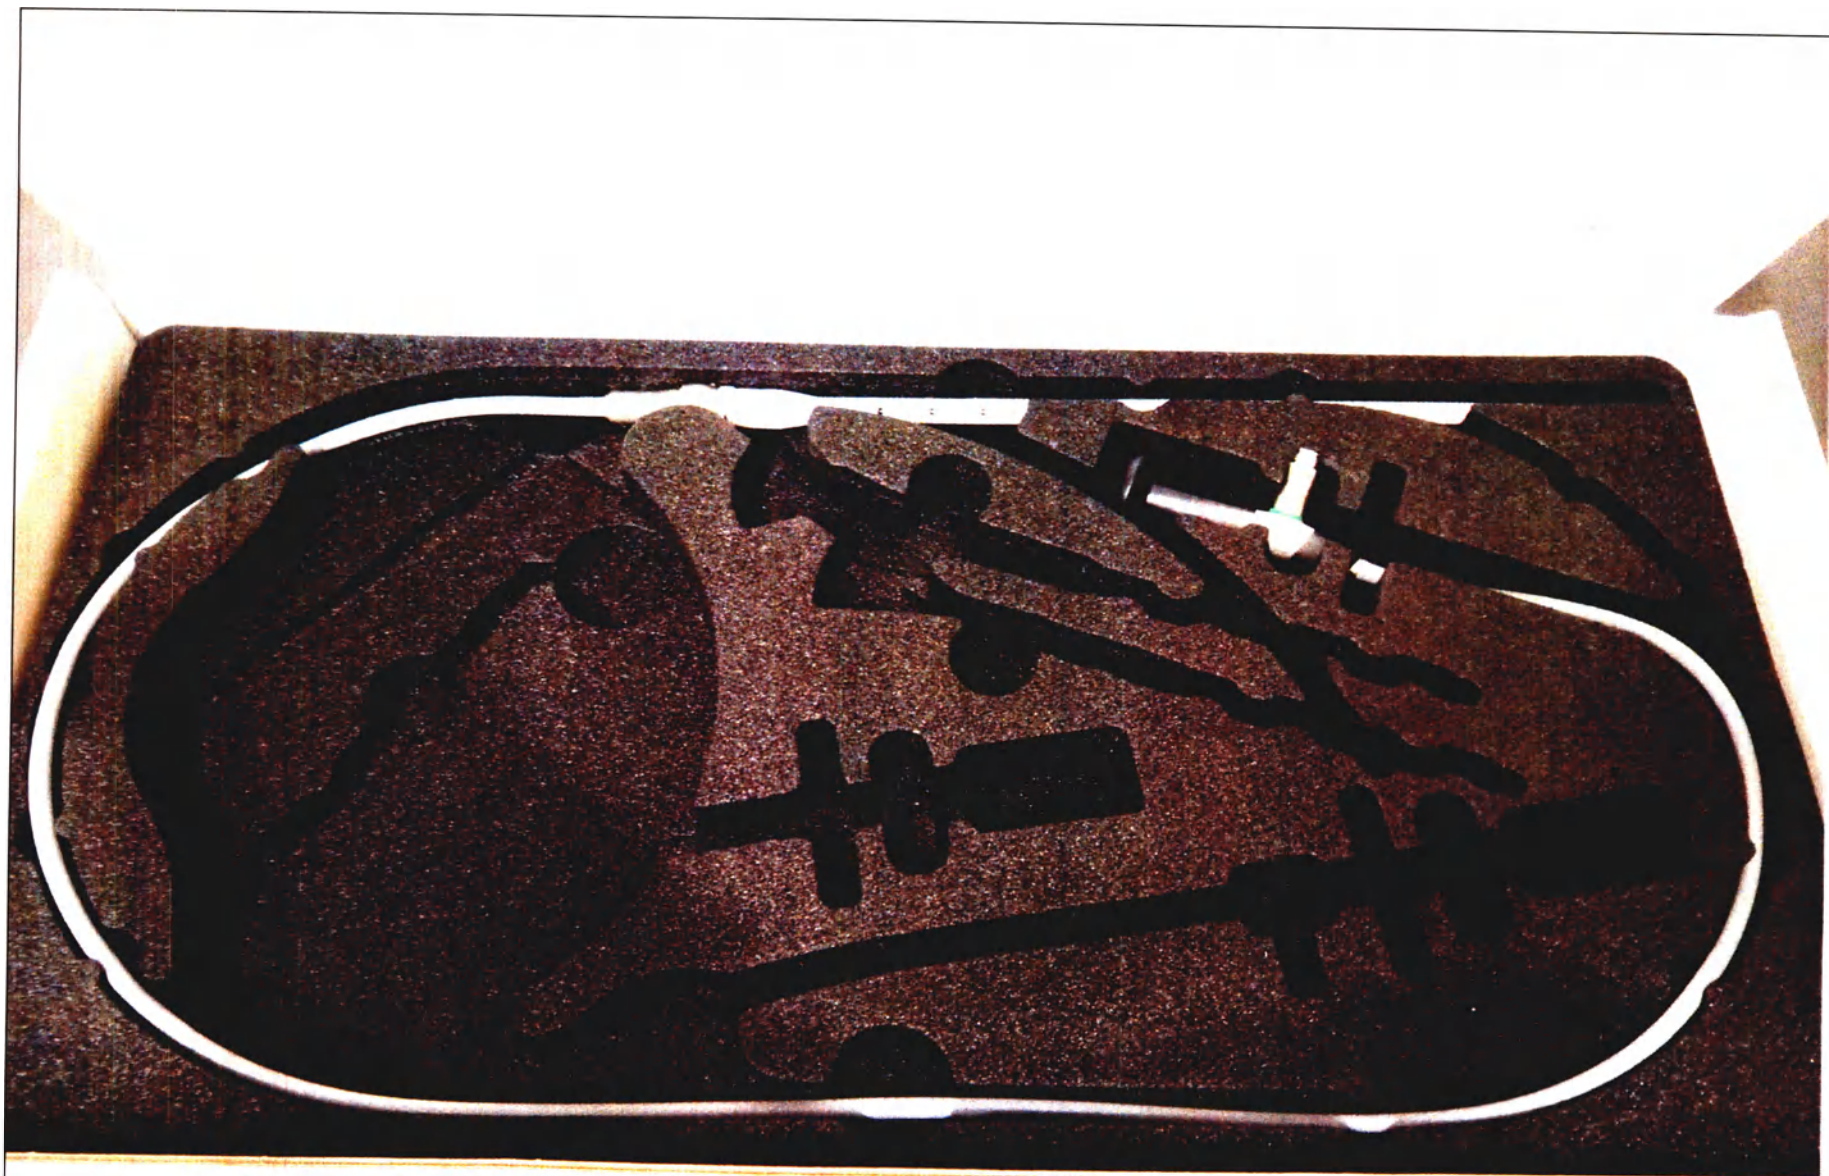


Рис. 1. Бронхоскоп жесткий миниатюрный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 30,6 см

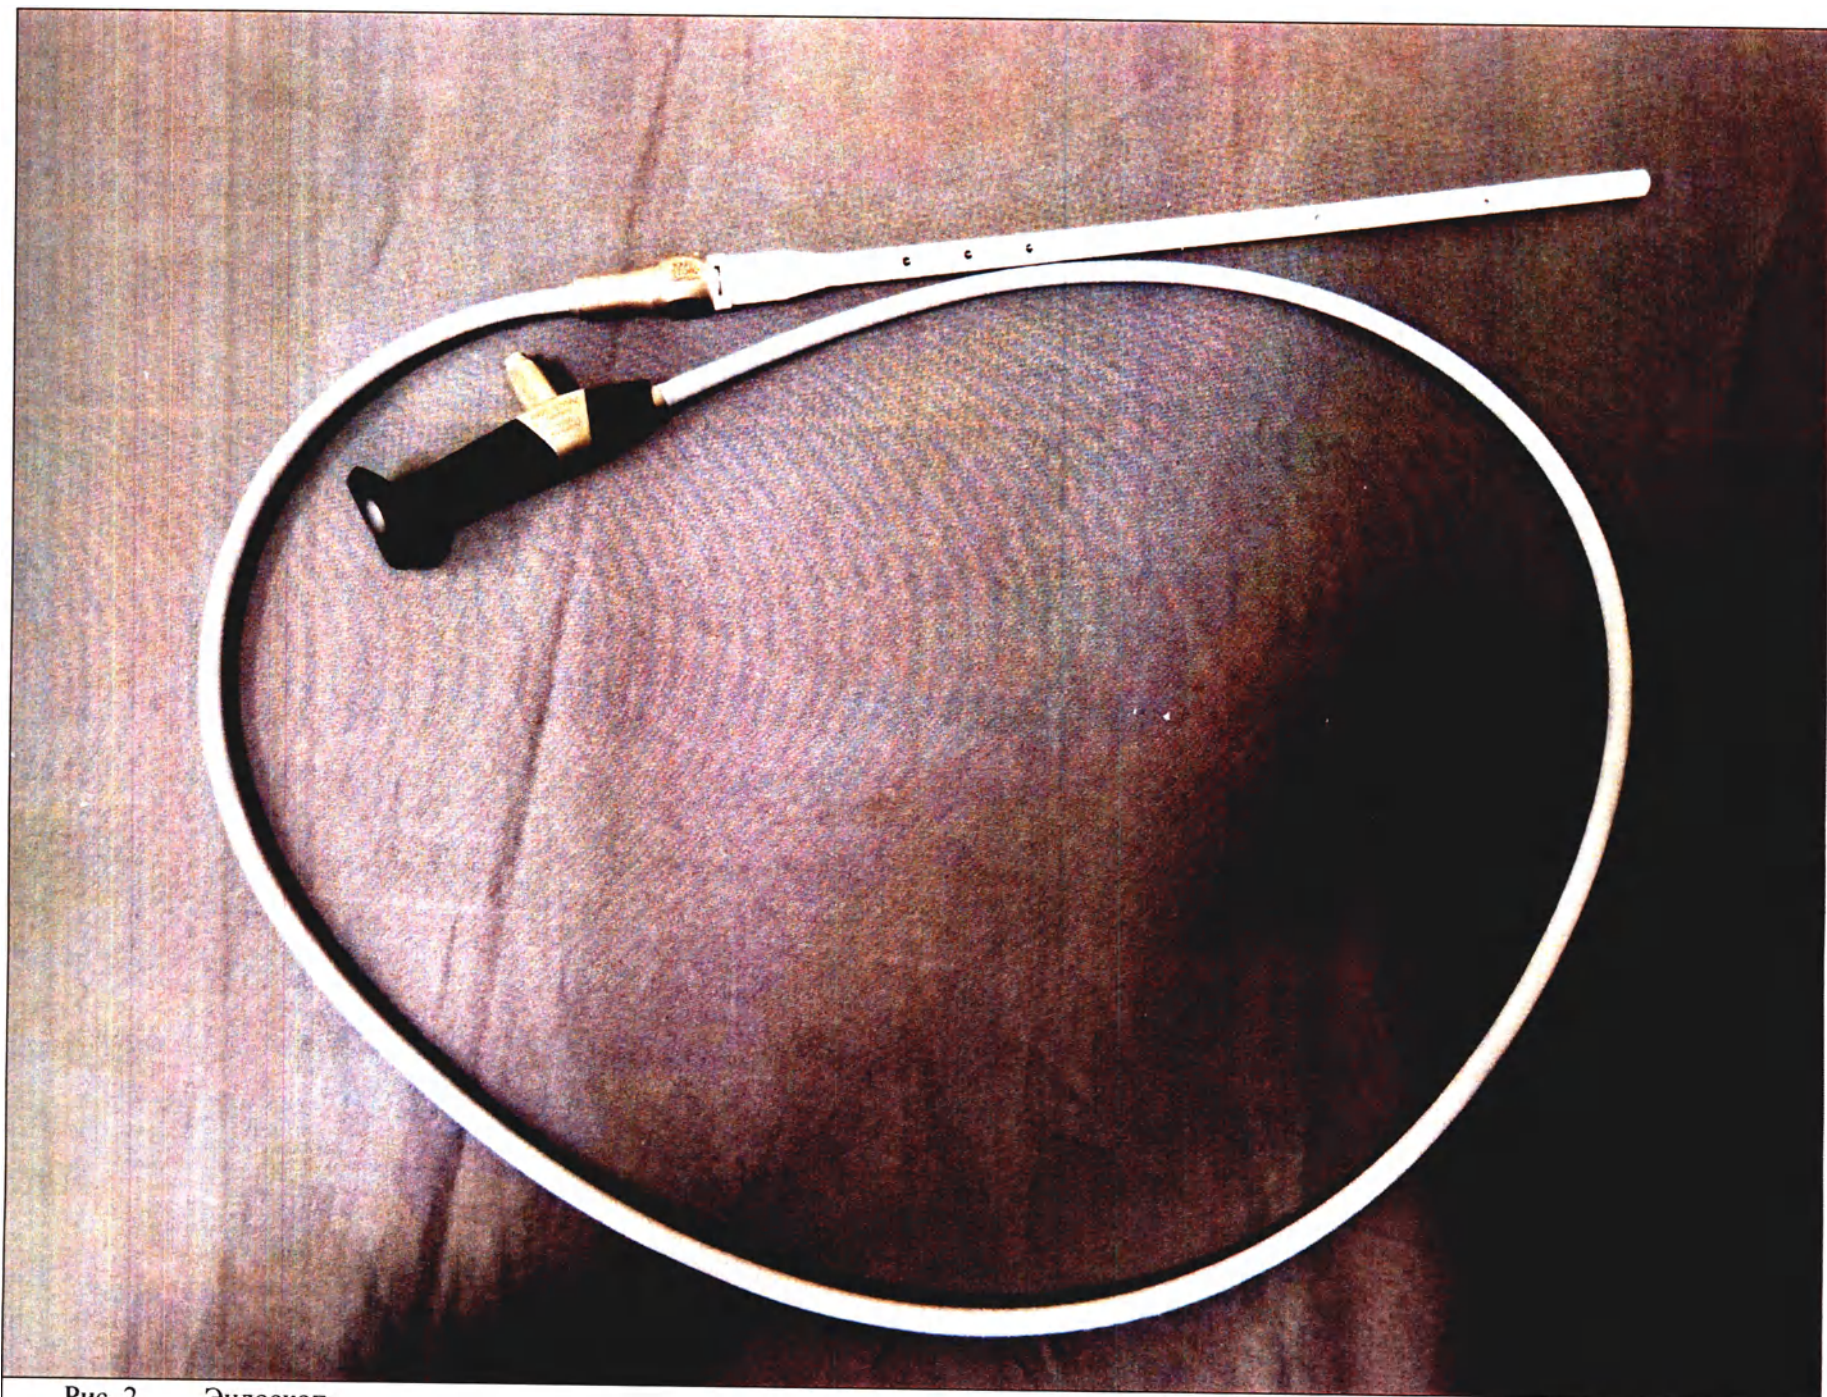


Рис. 2. Эндоскоп

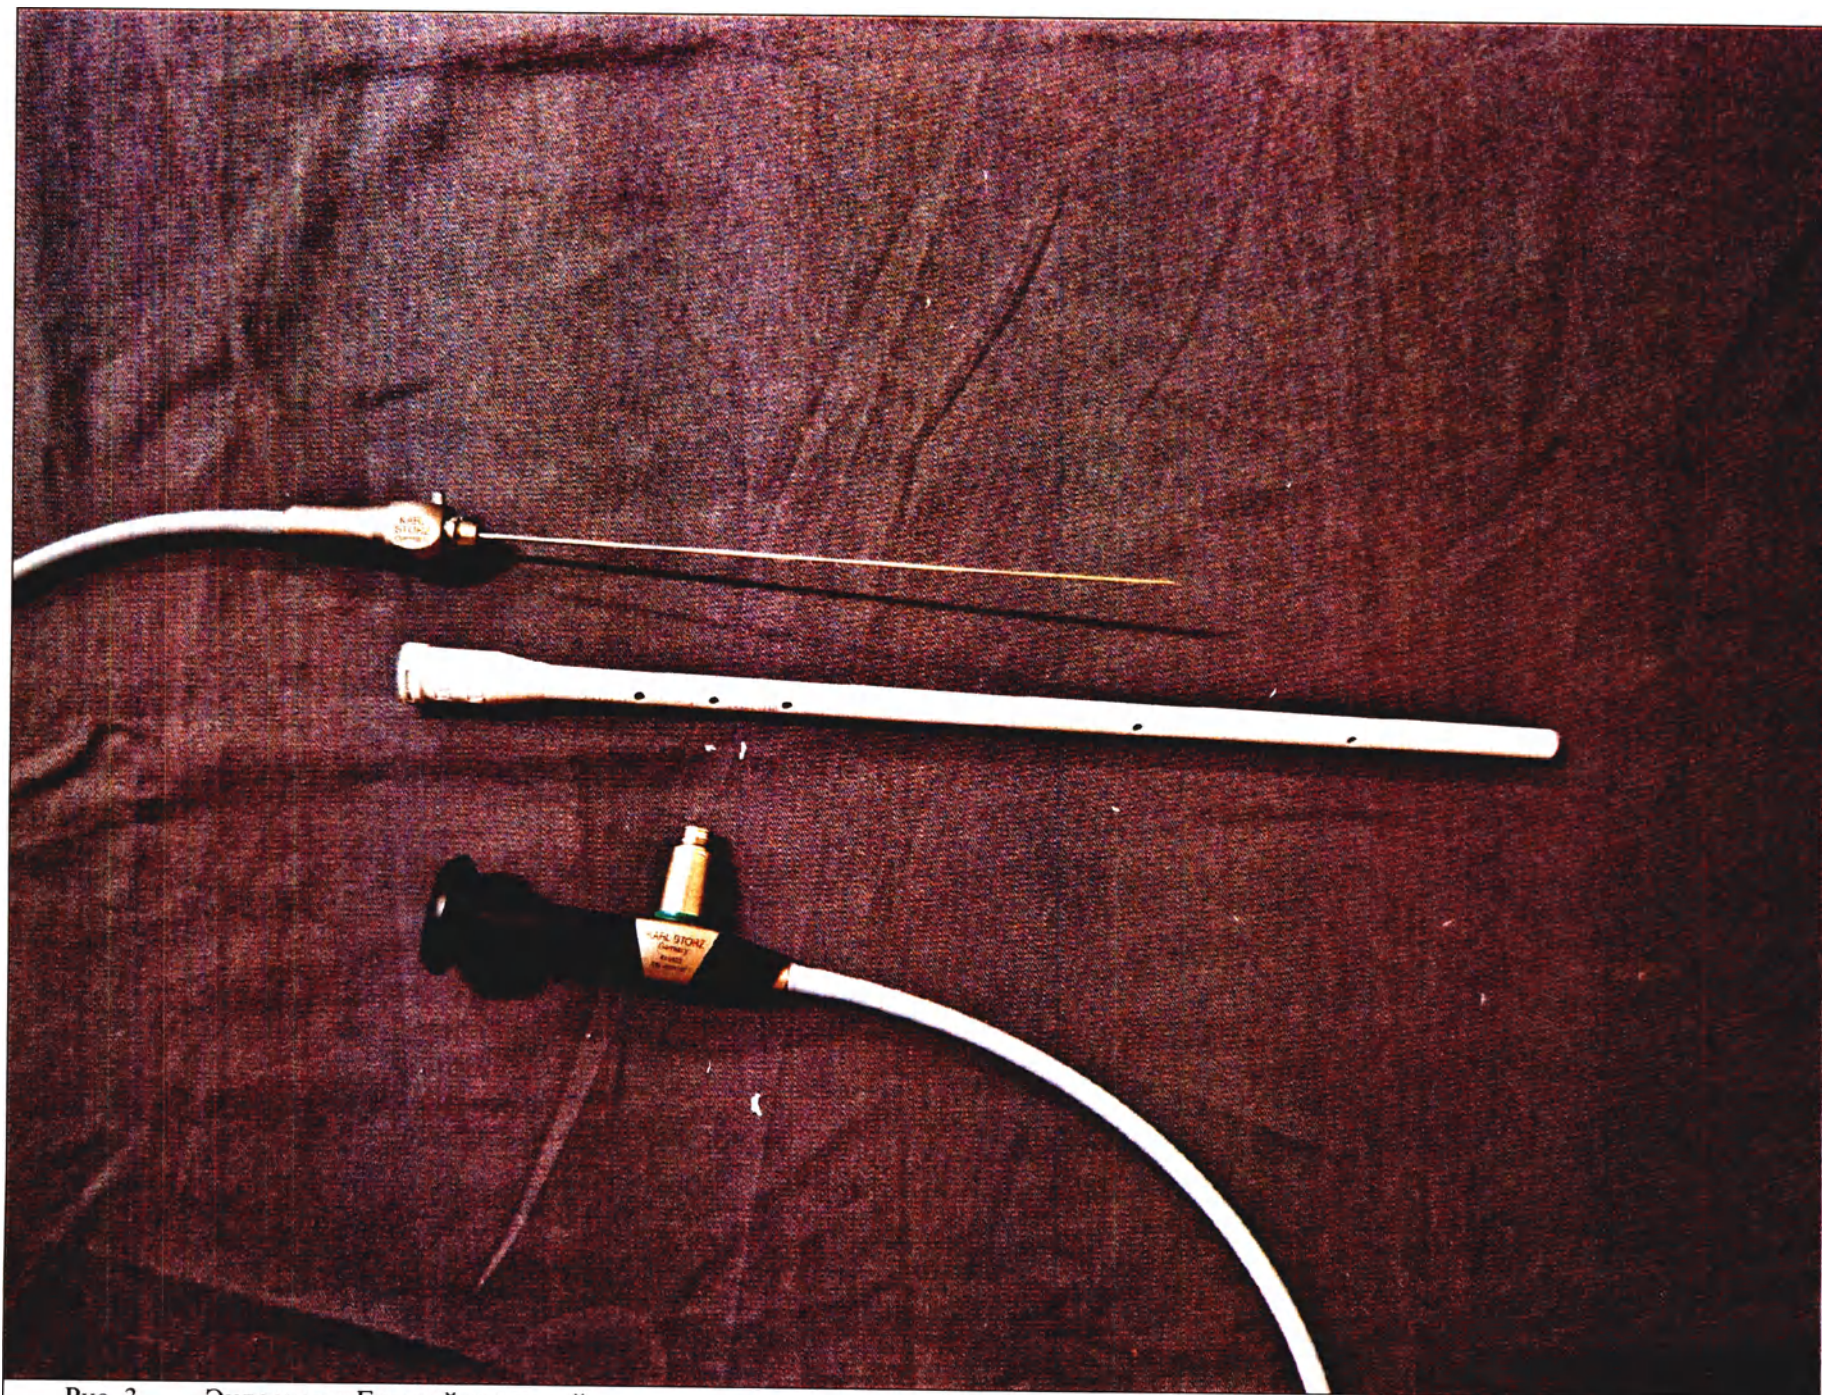


Рис. 3. Эндоскоп с Гильзой защитной

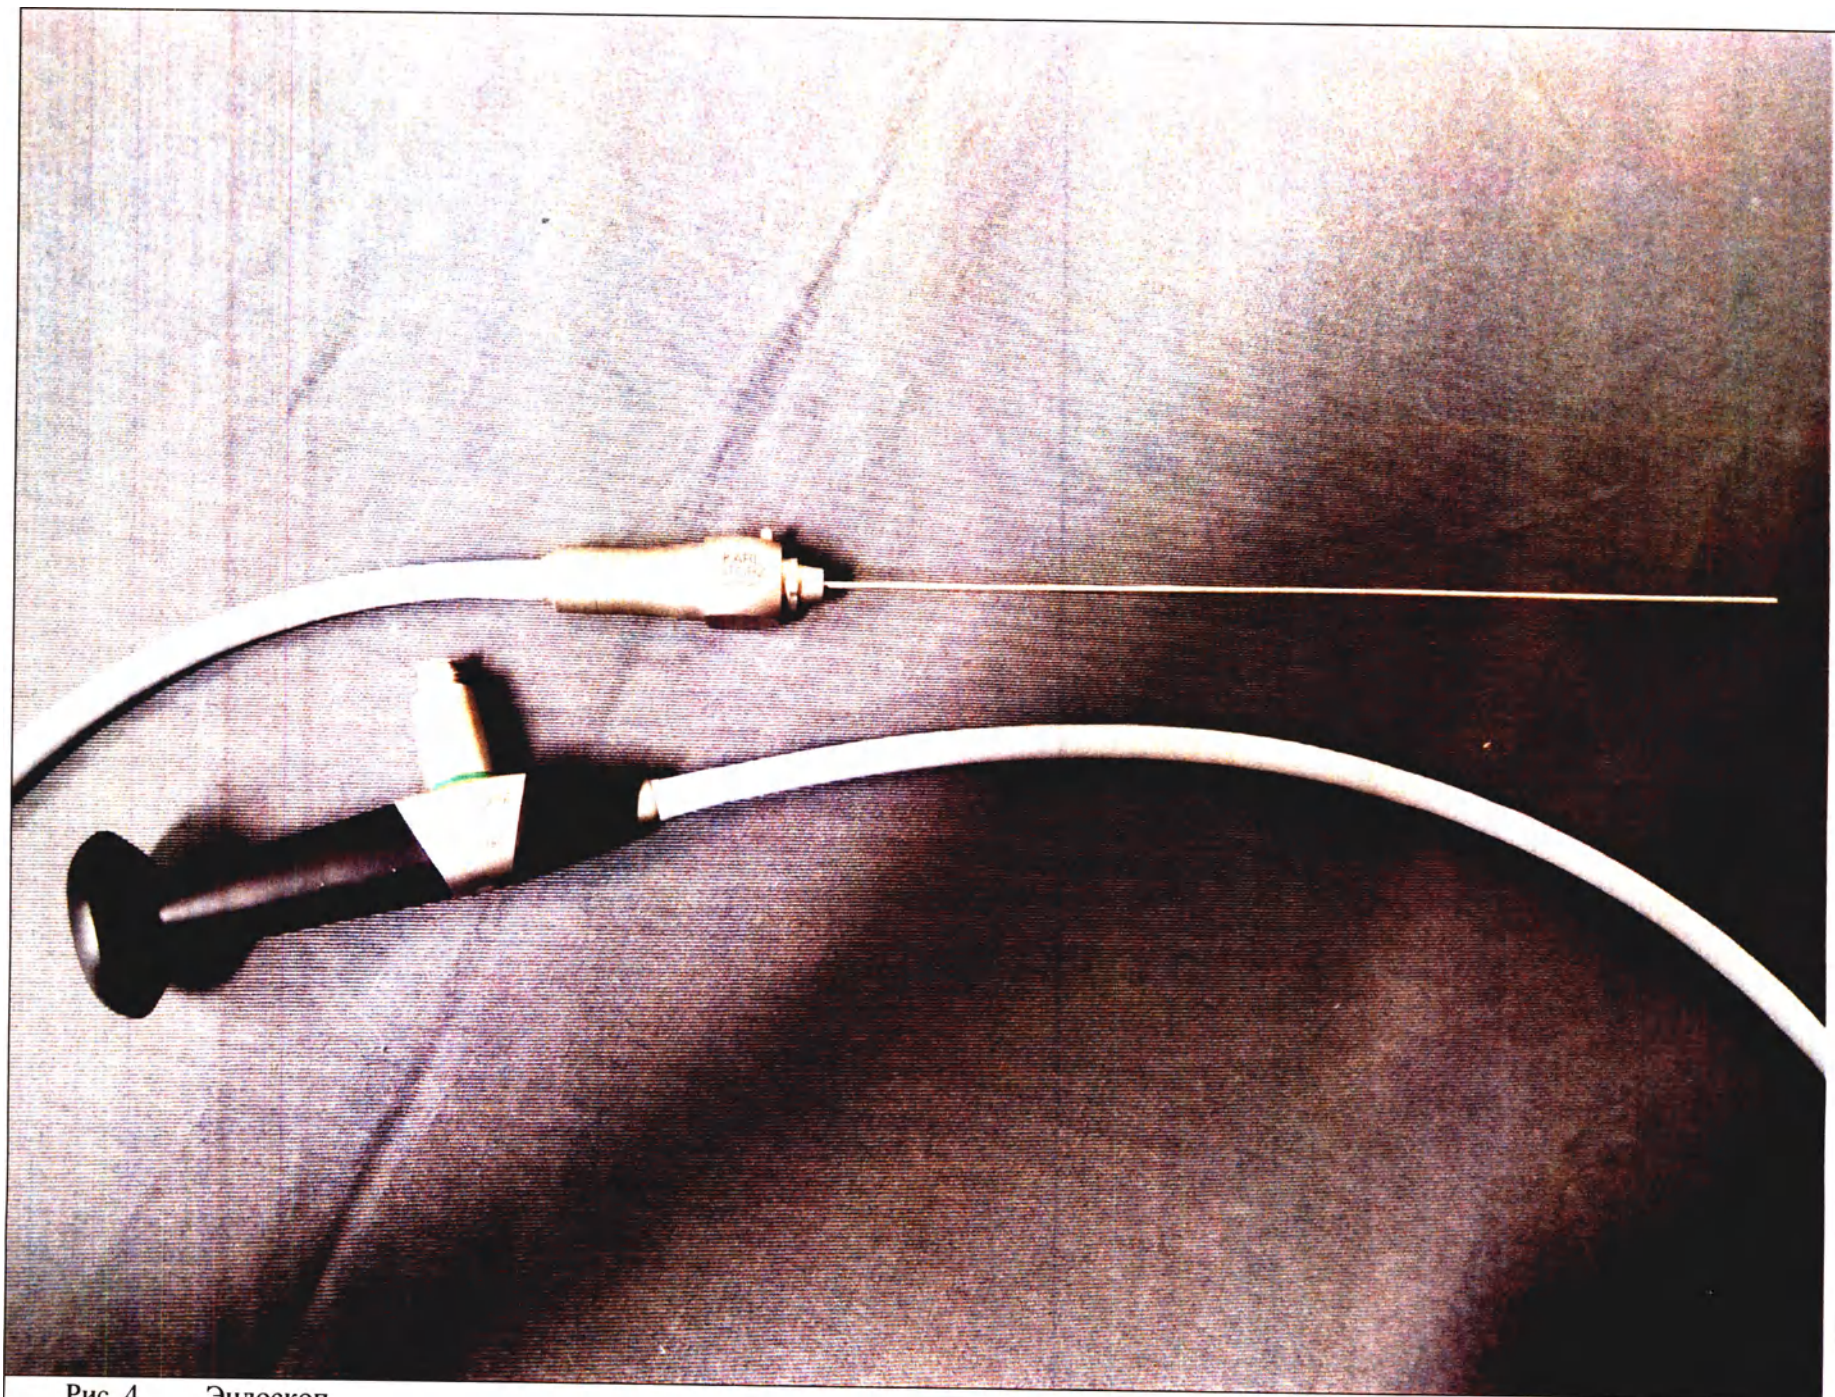


Рис. 4. Эндоскоп

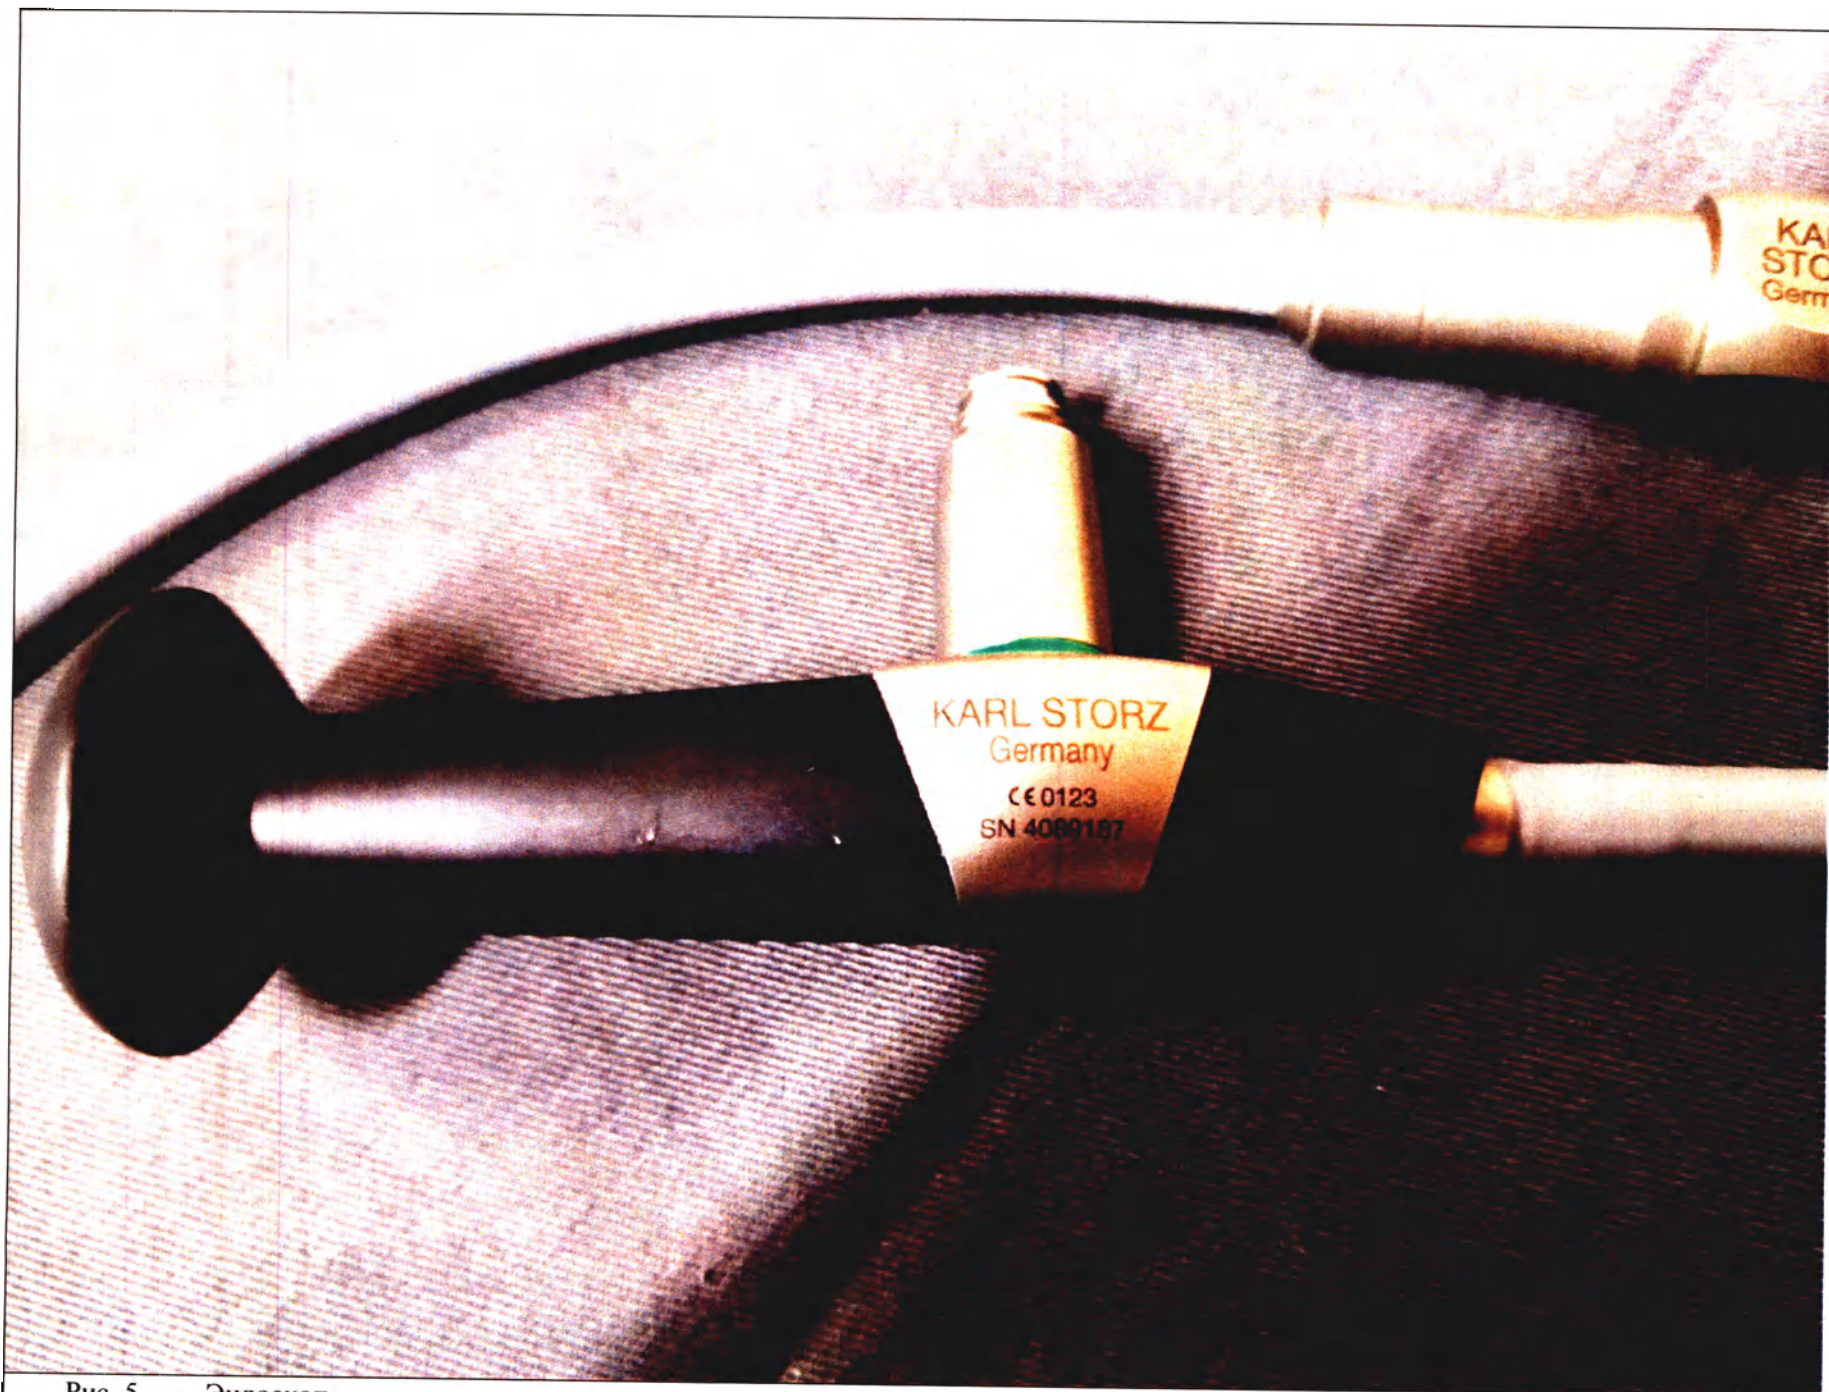


Рис. 5. Эндоскоп

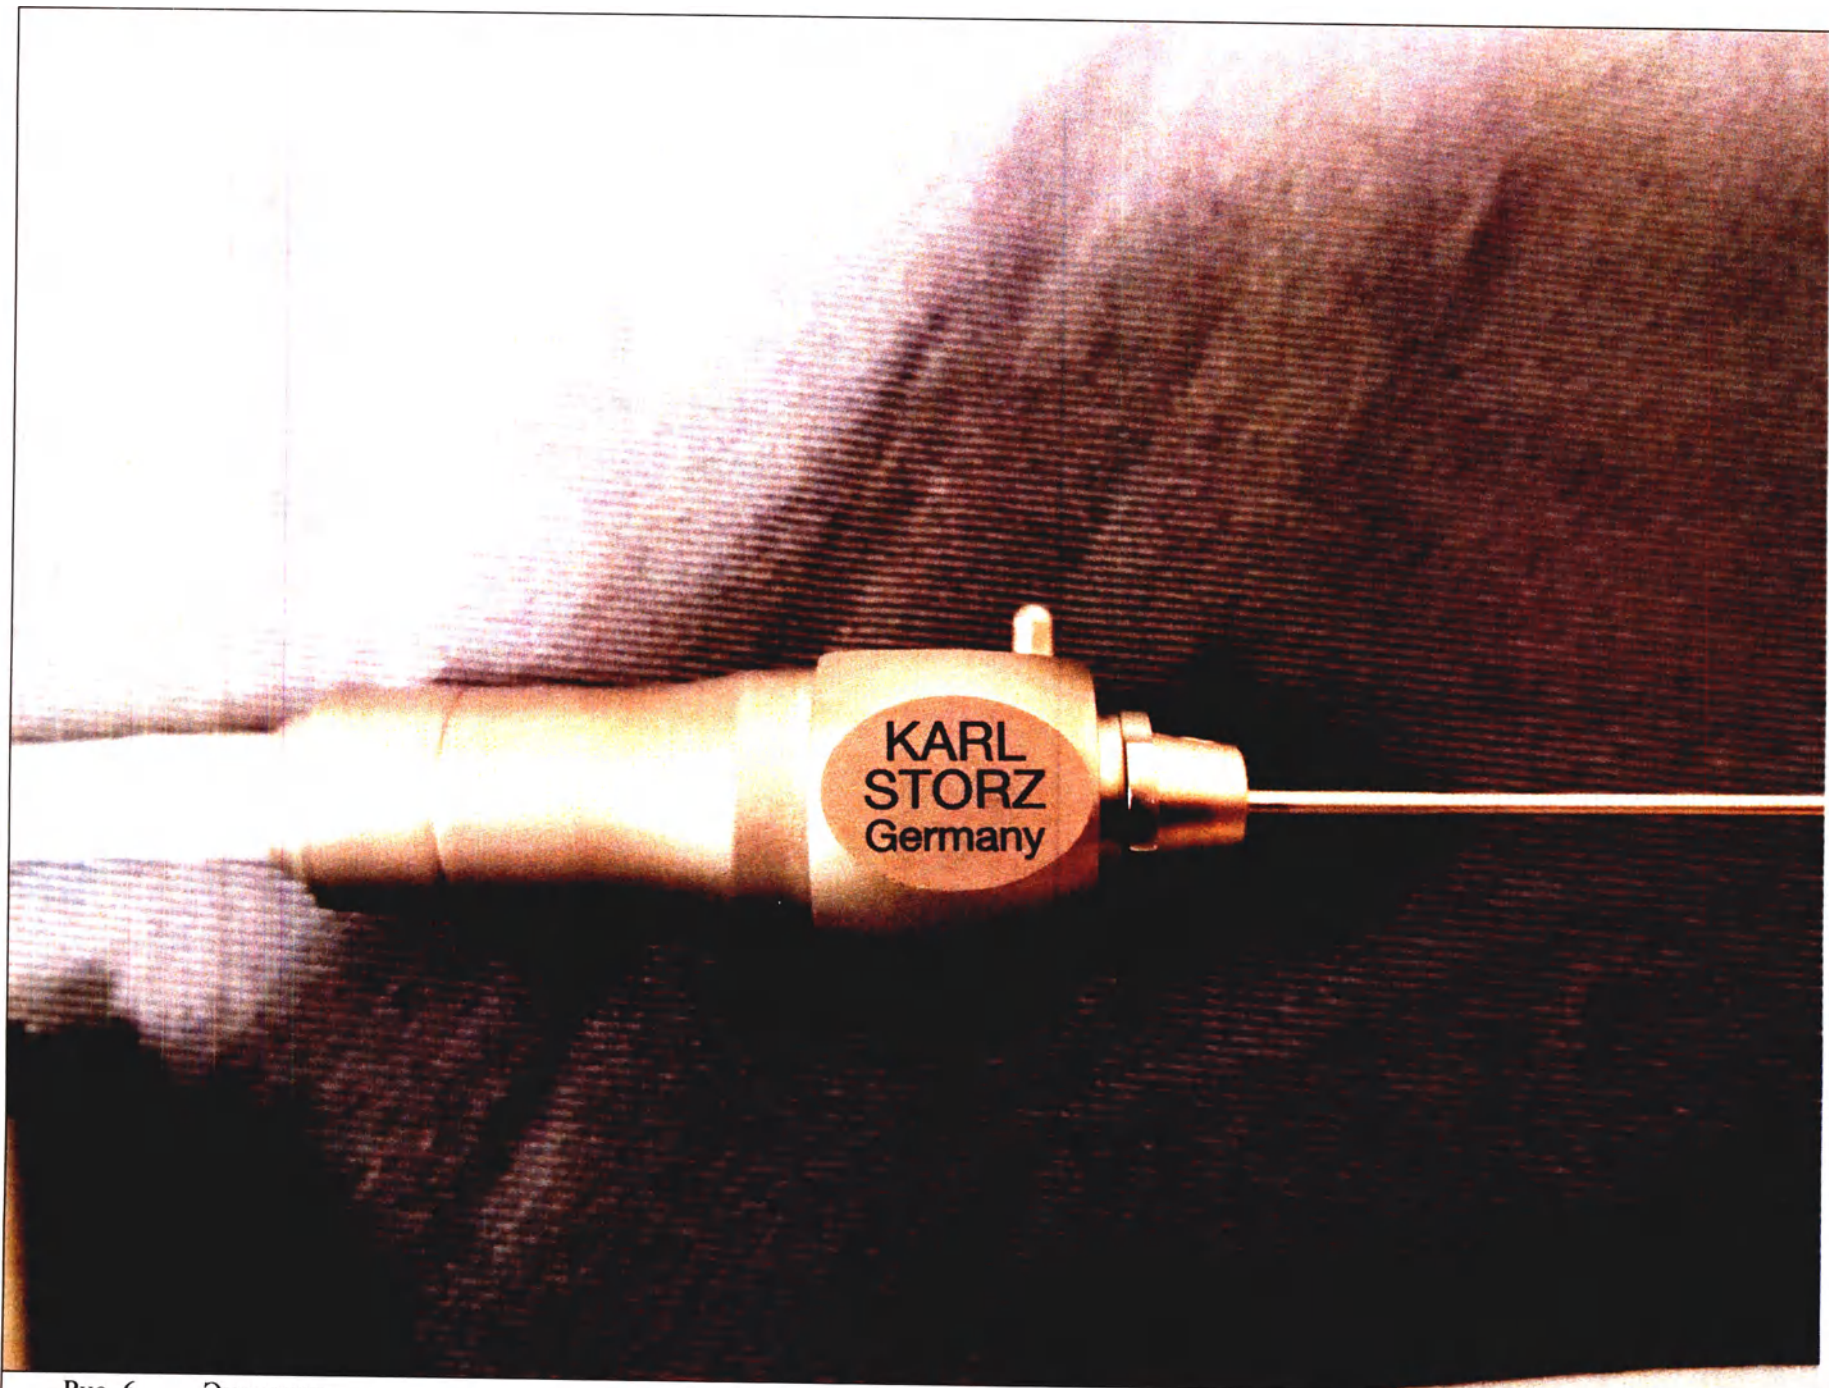


Рис. 6. Эндоскоп

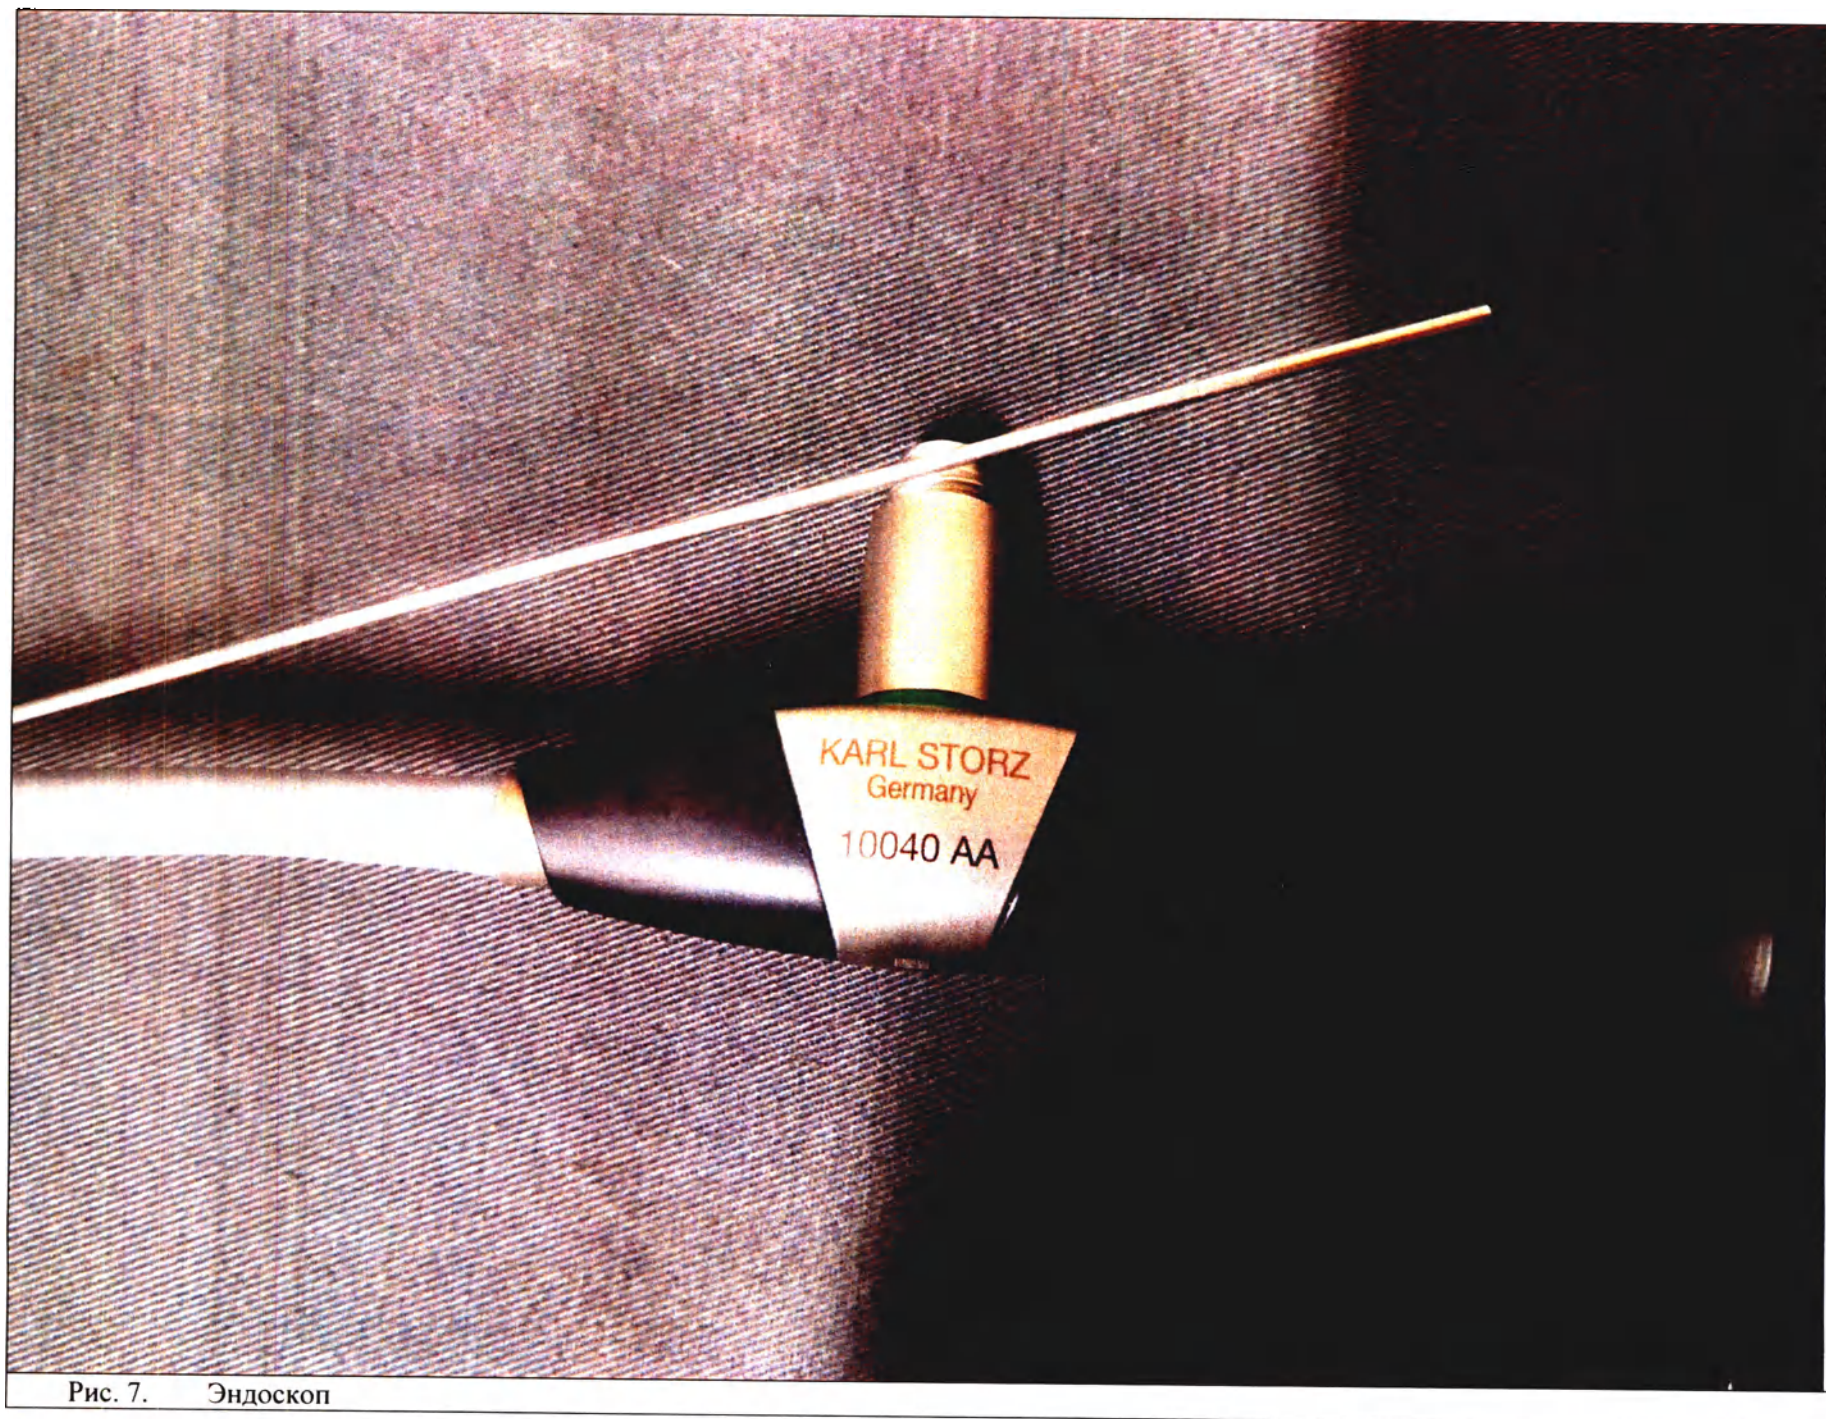


Рис. 7. Эндоскоп

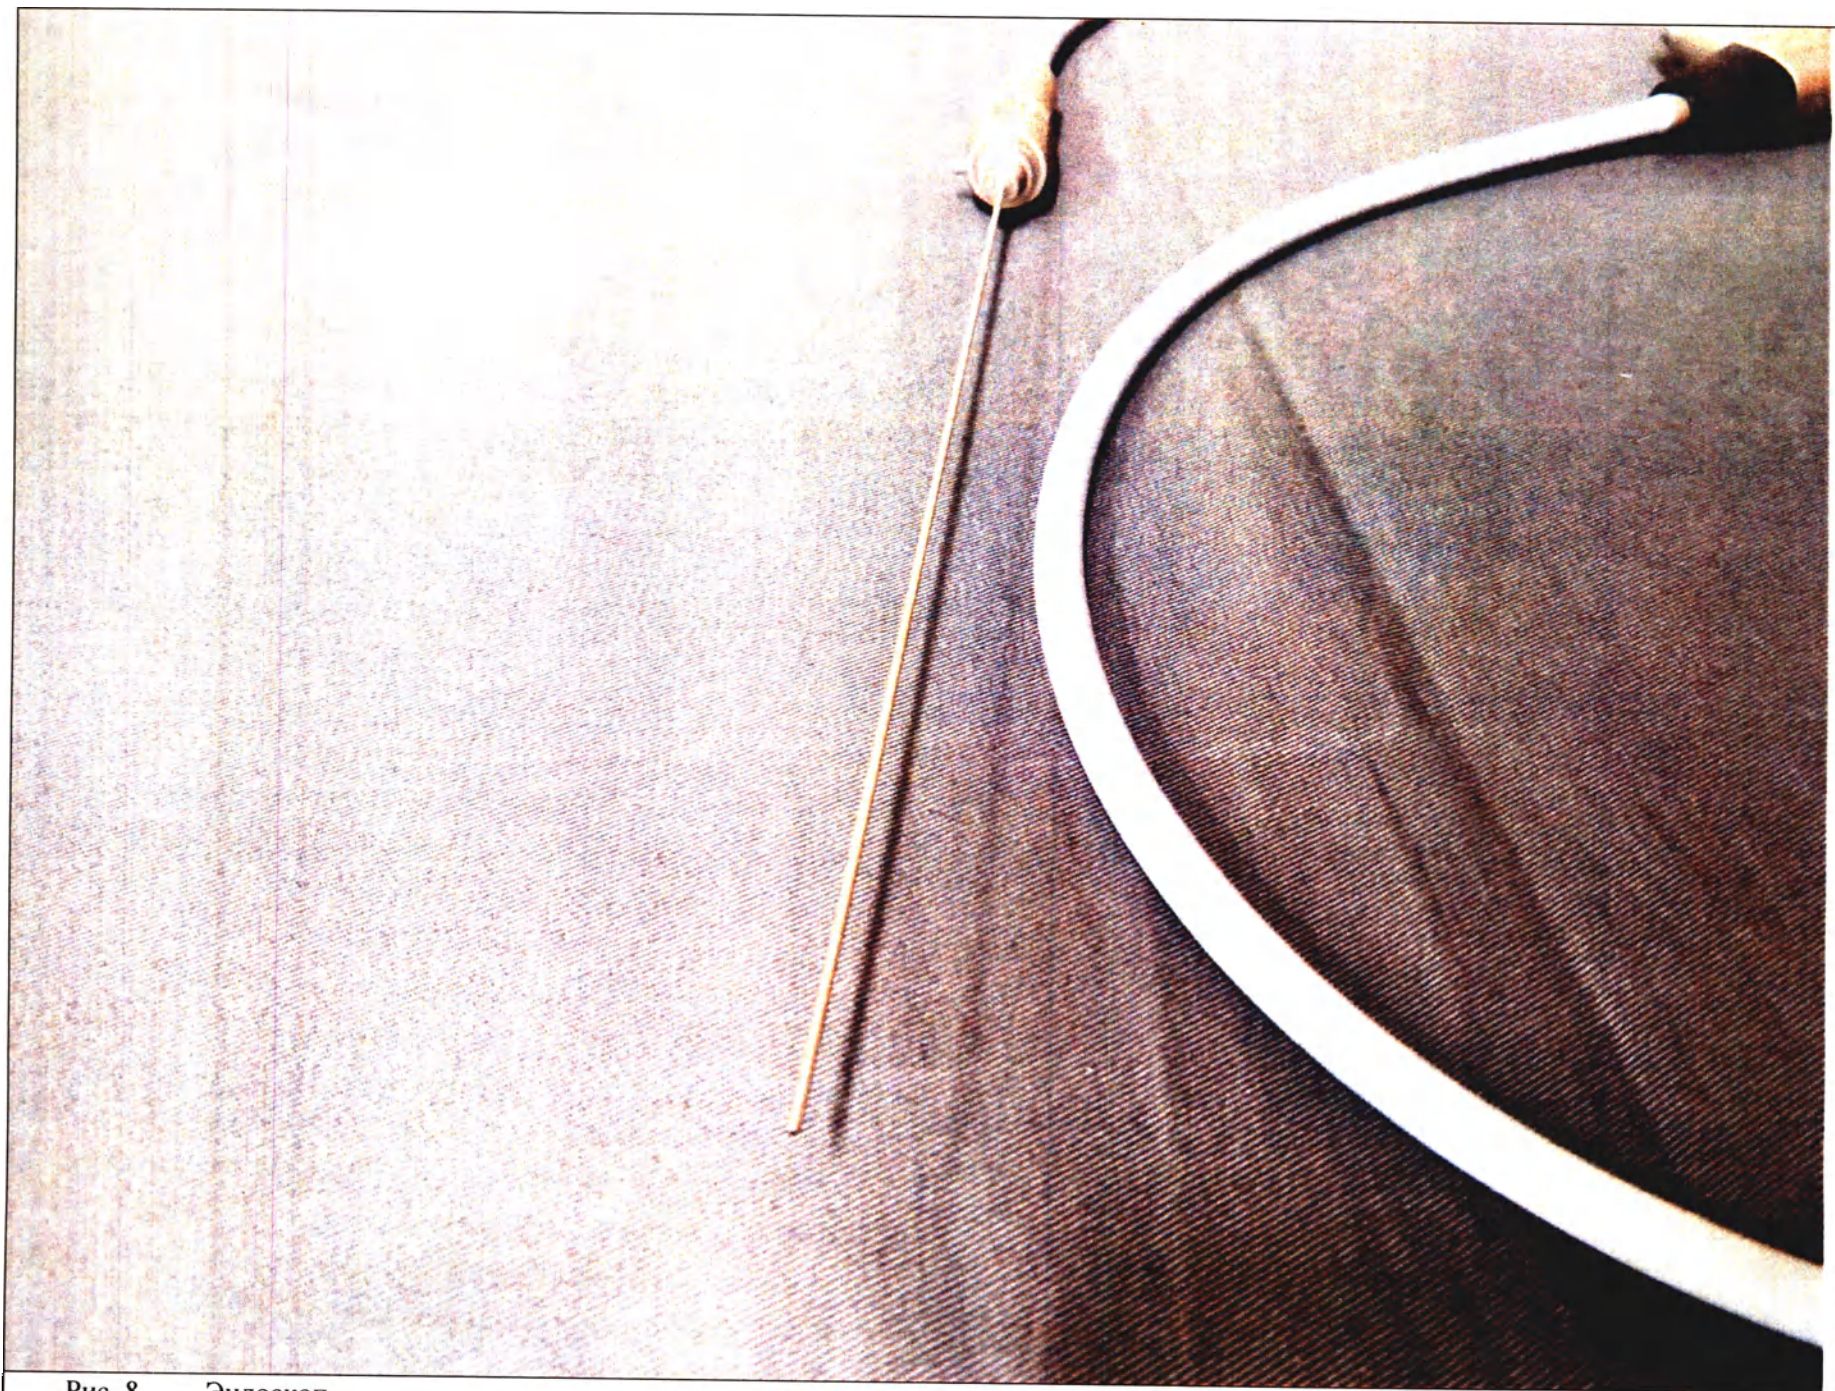


Рис. 8. Эндоскоп

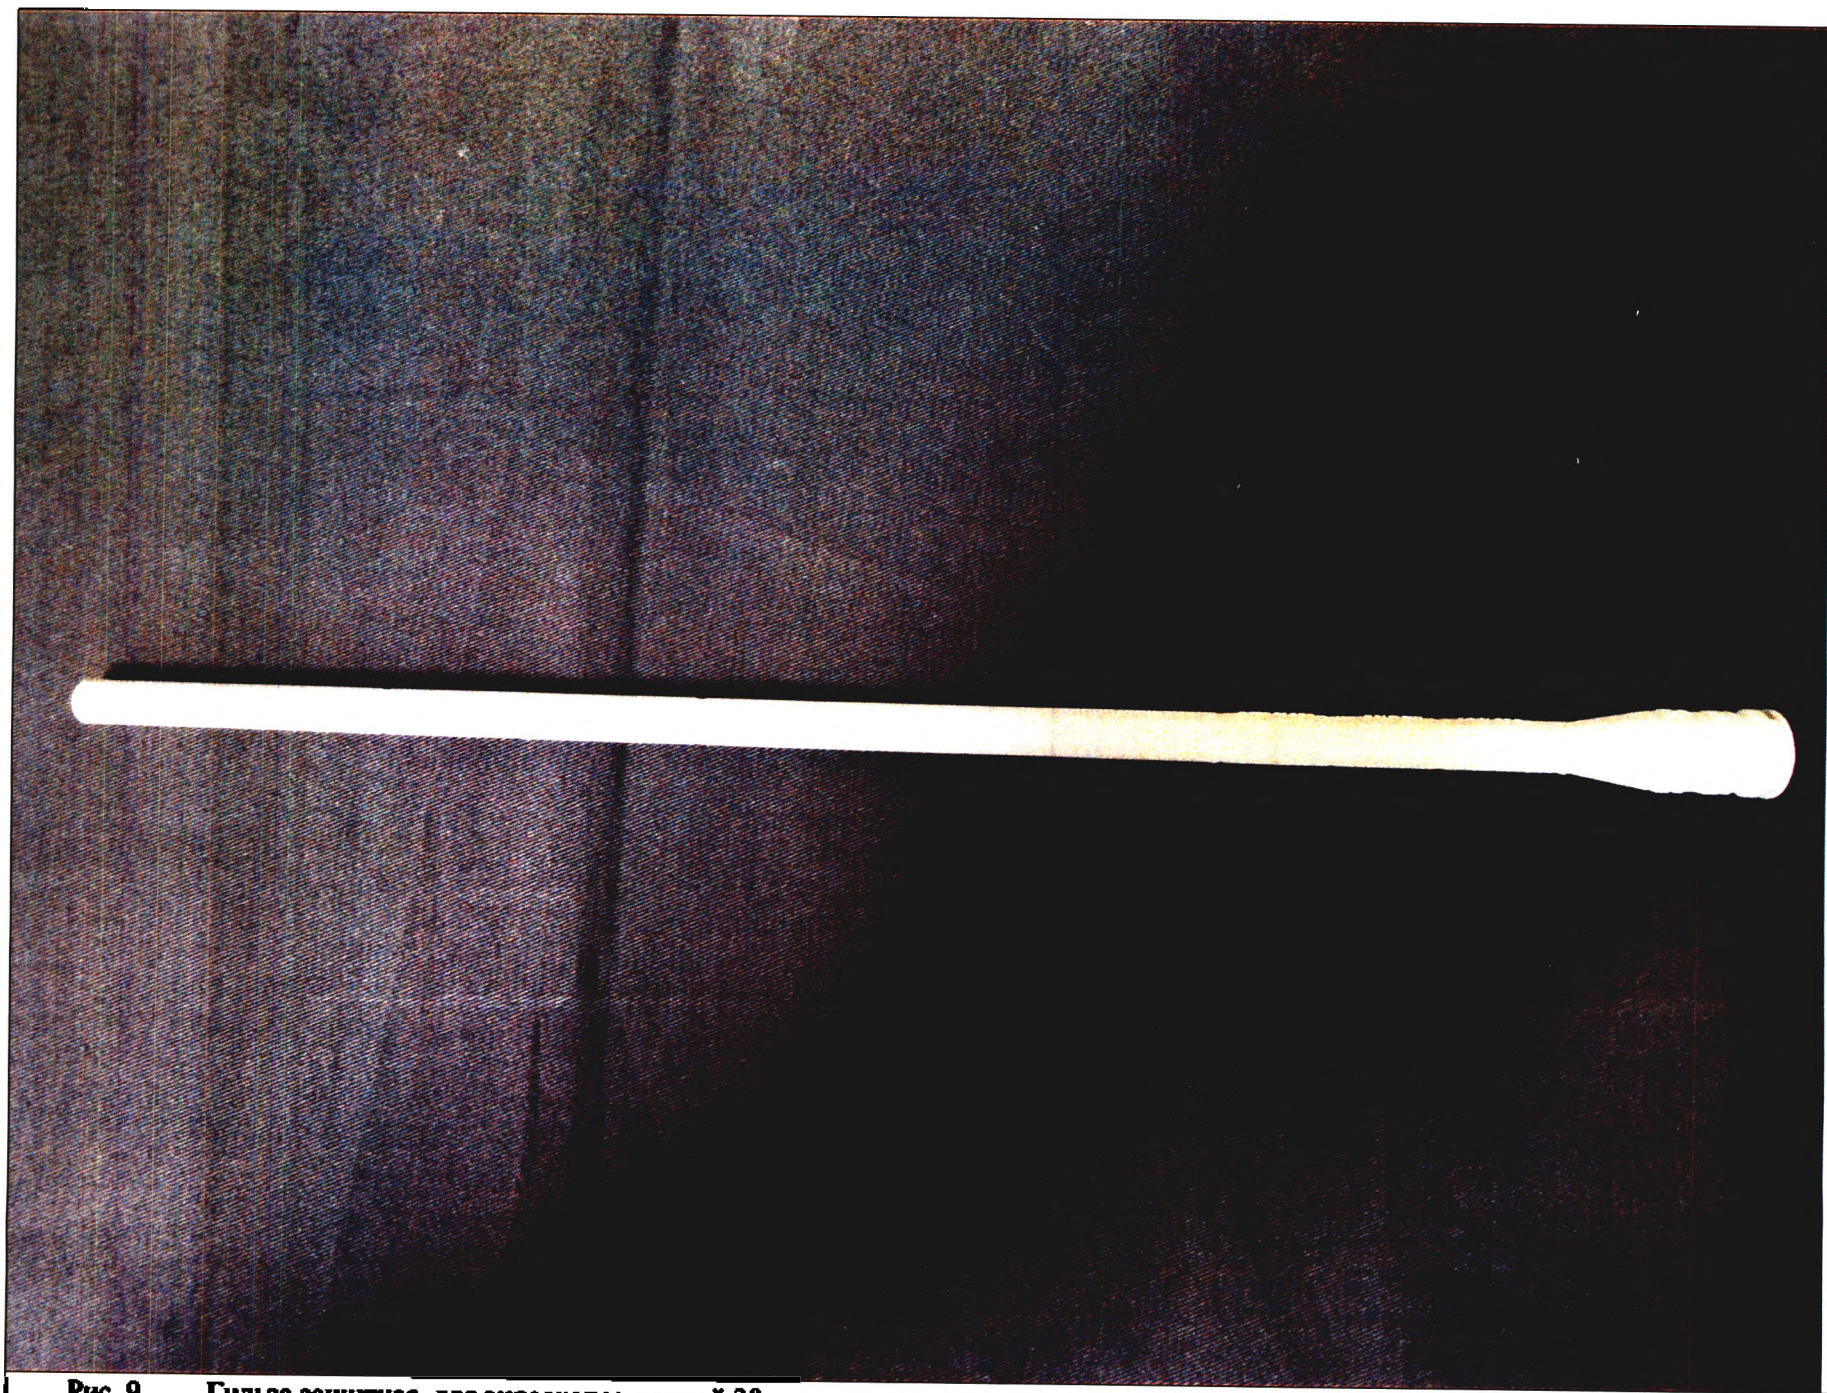


Рис. 9. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см

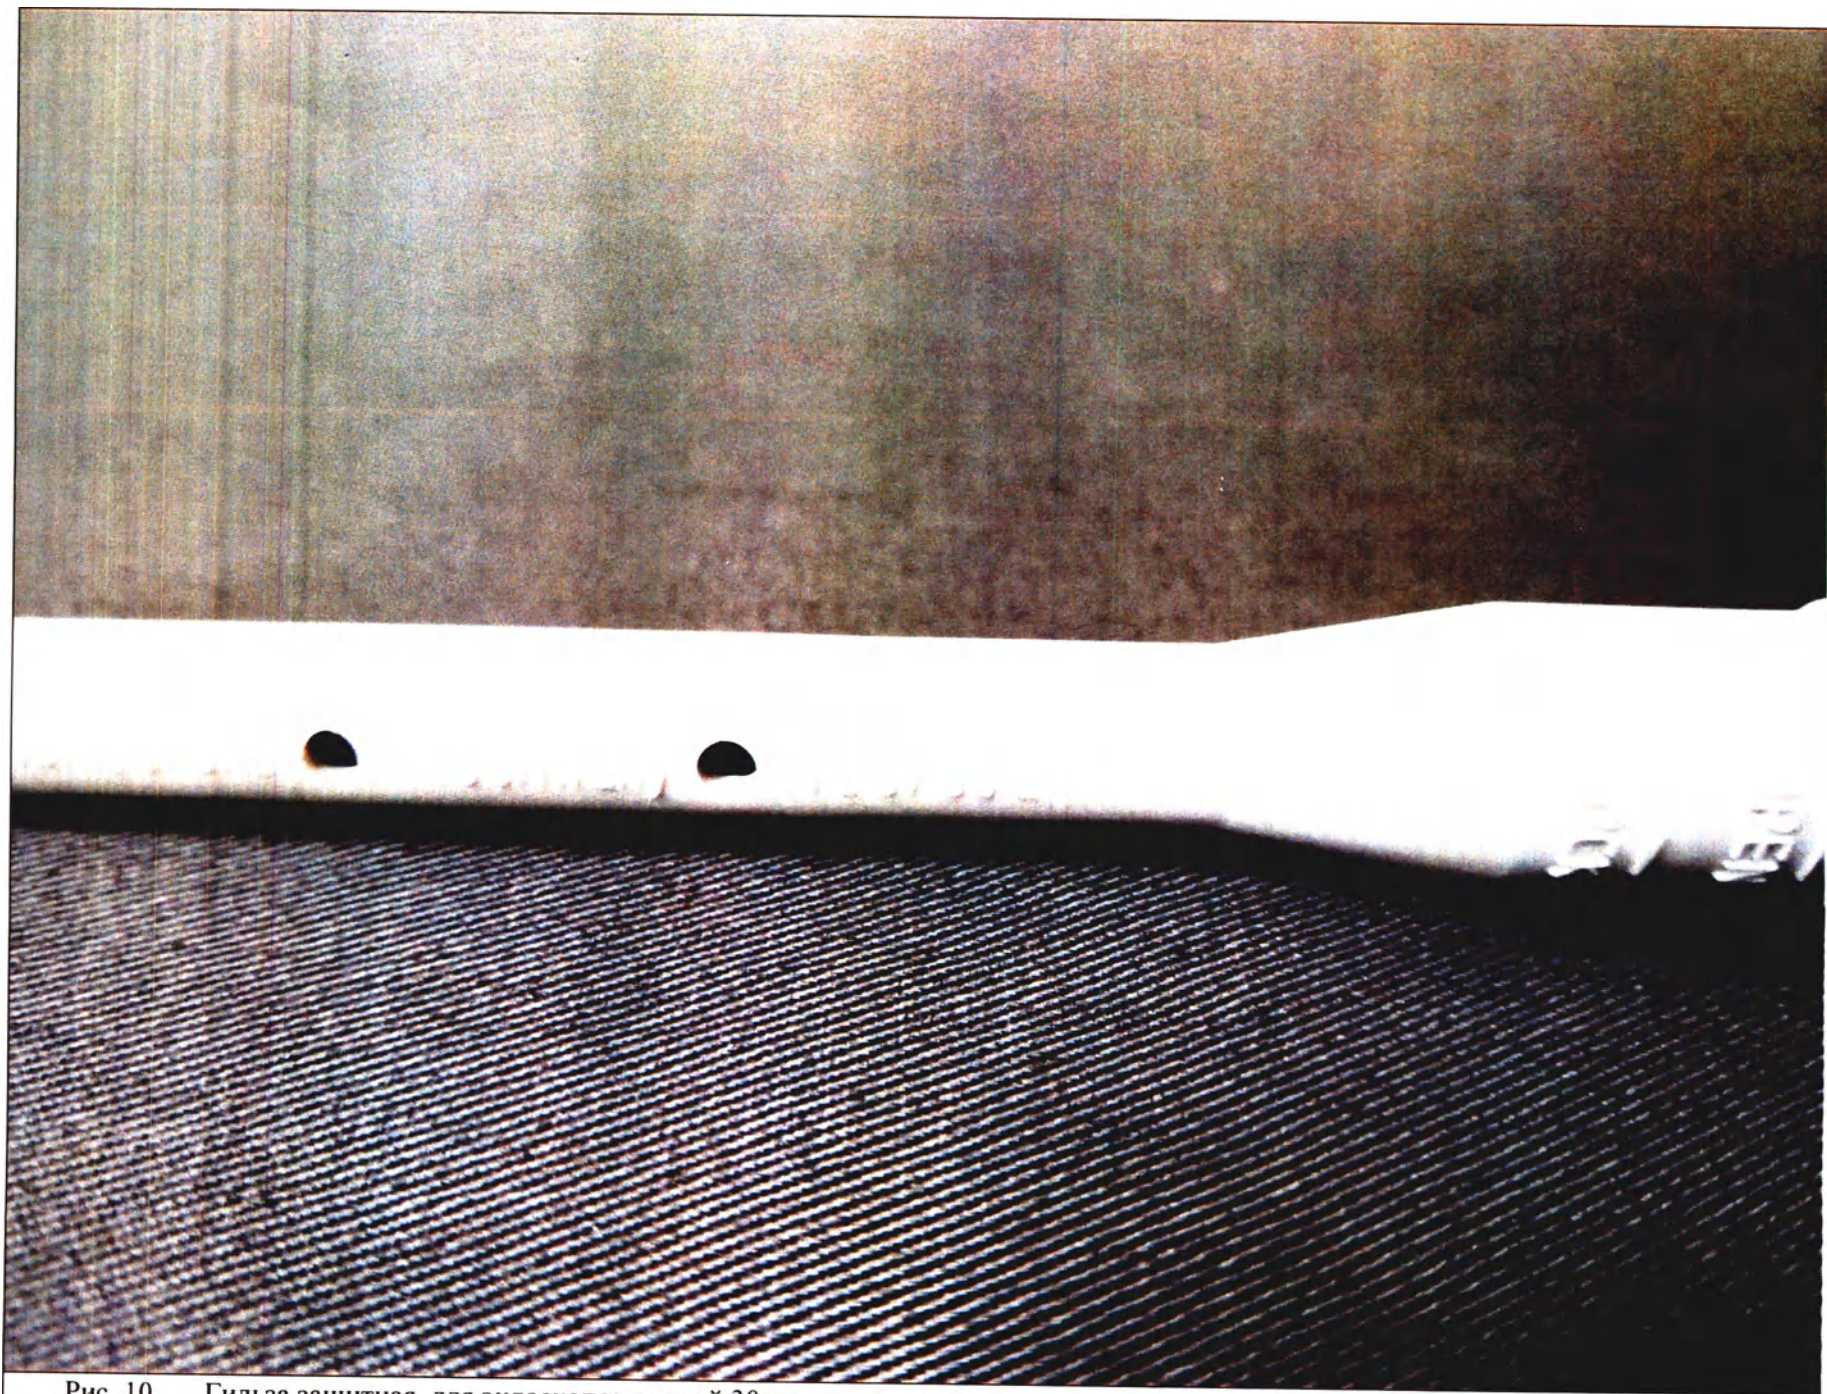


Рис. 10. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см



Рис. 11. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см

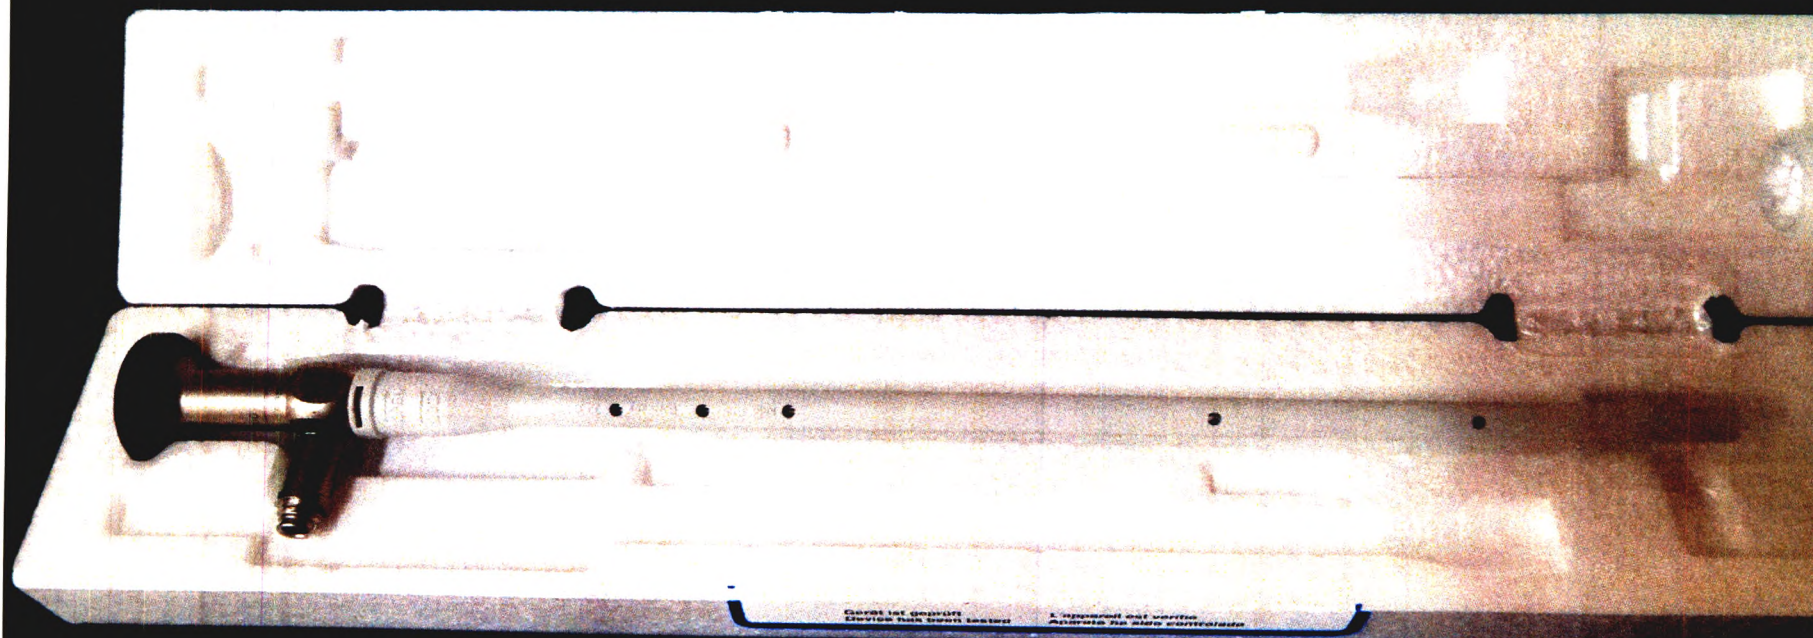


Рис. 12. Бронхоскоп жесткий миниаторный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 18,8 см

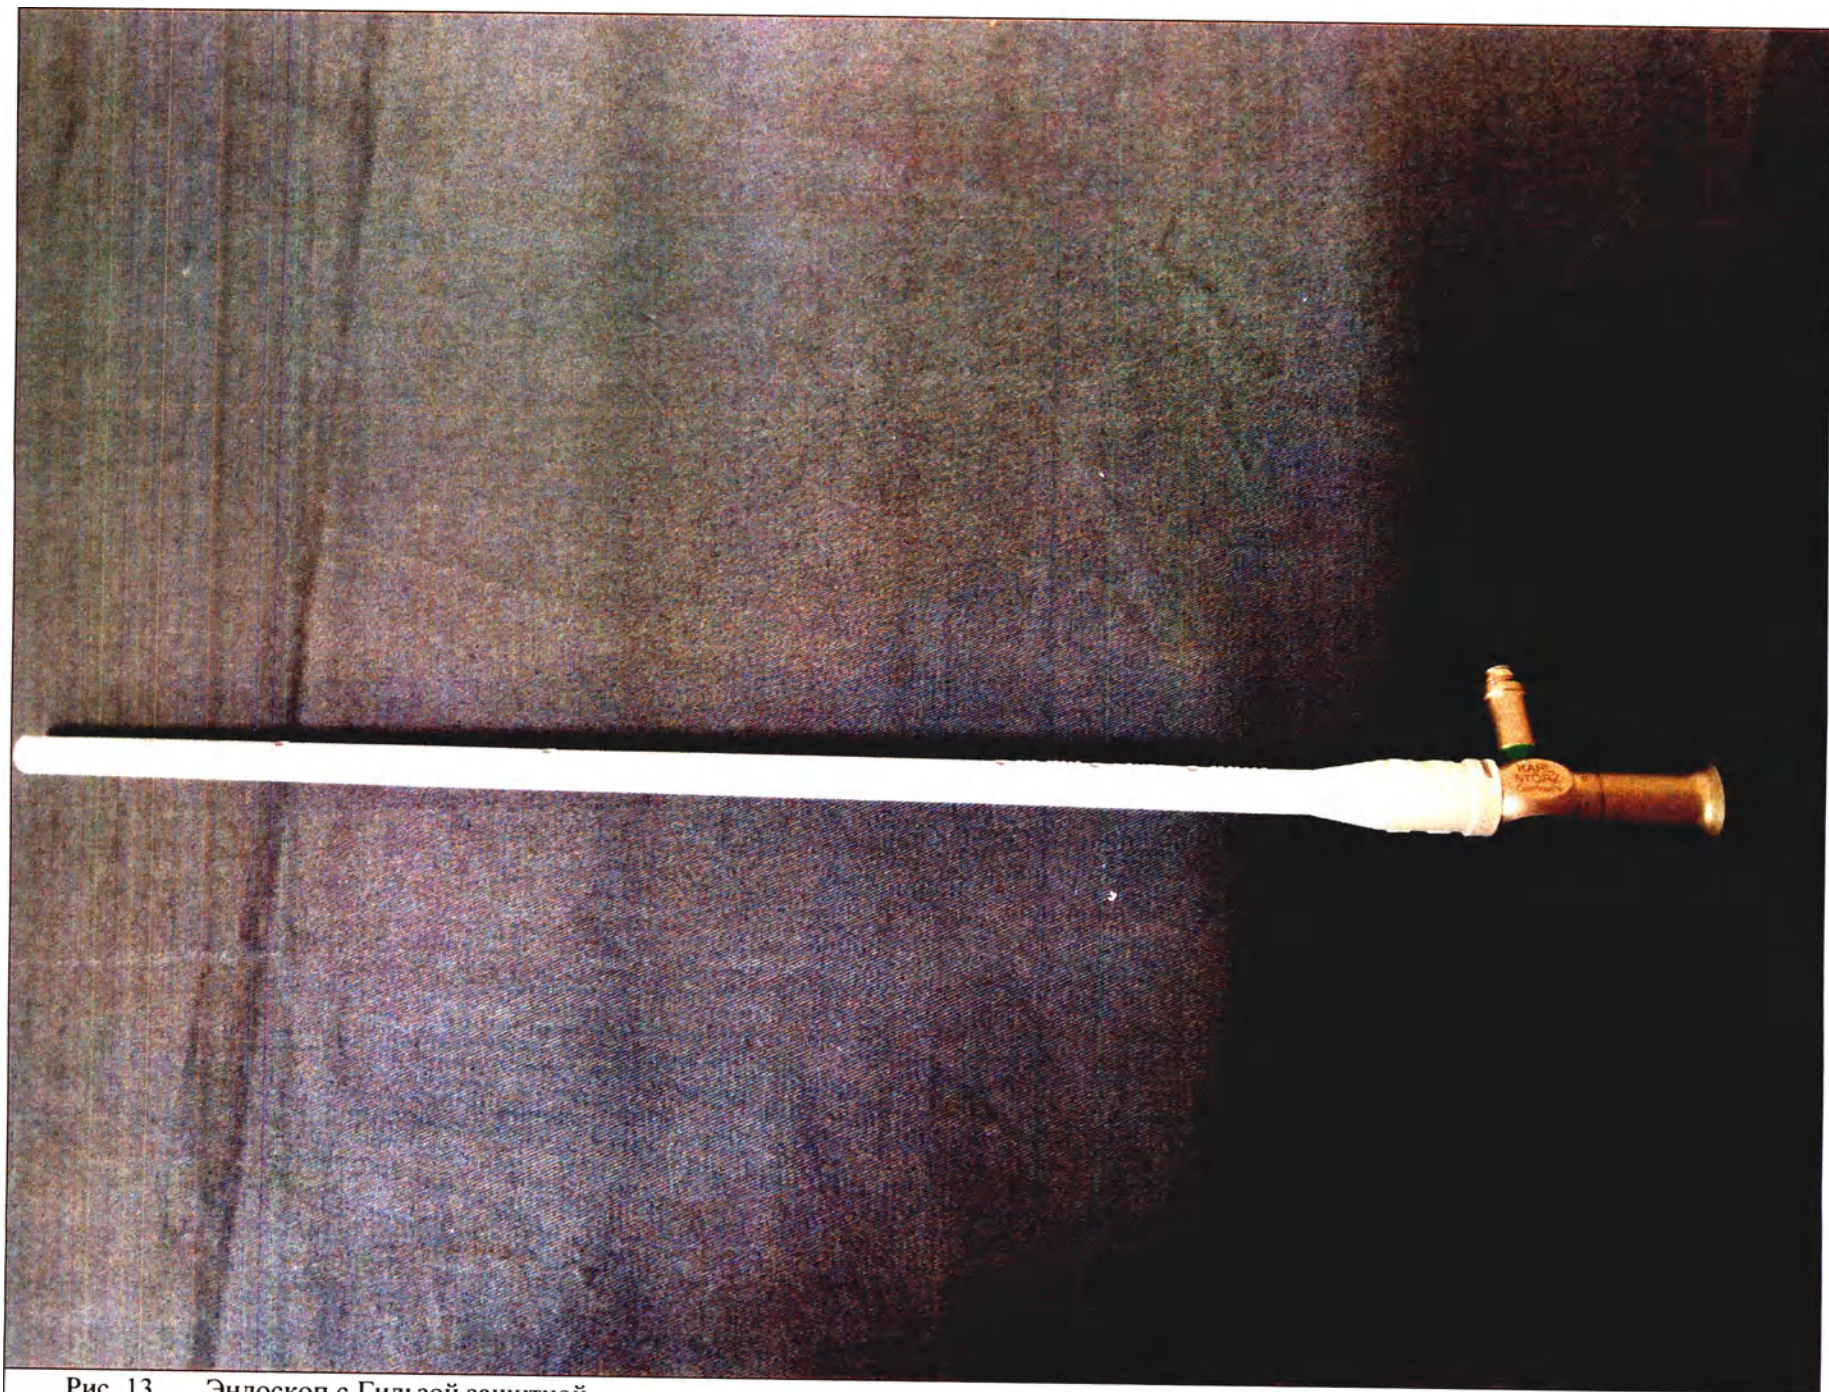


Рис. 13. Эндоскоп с Гильзой защитной

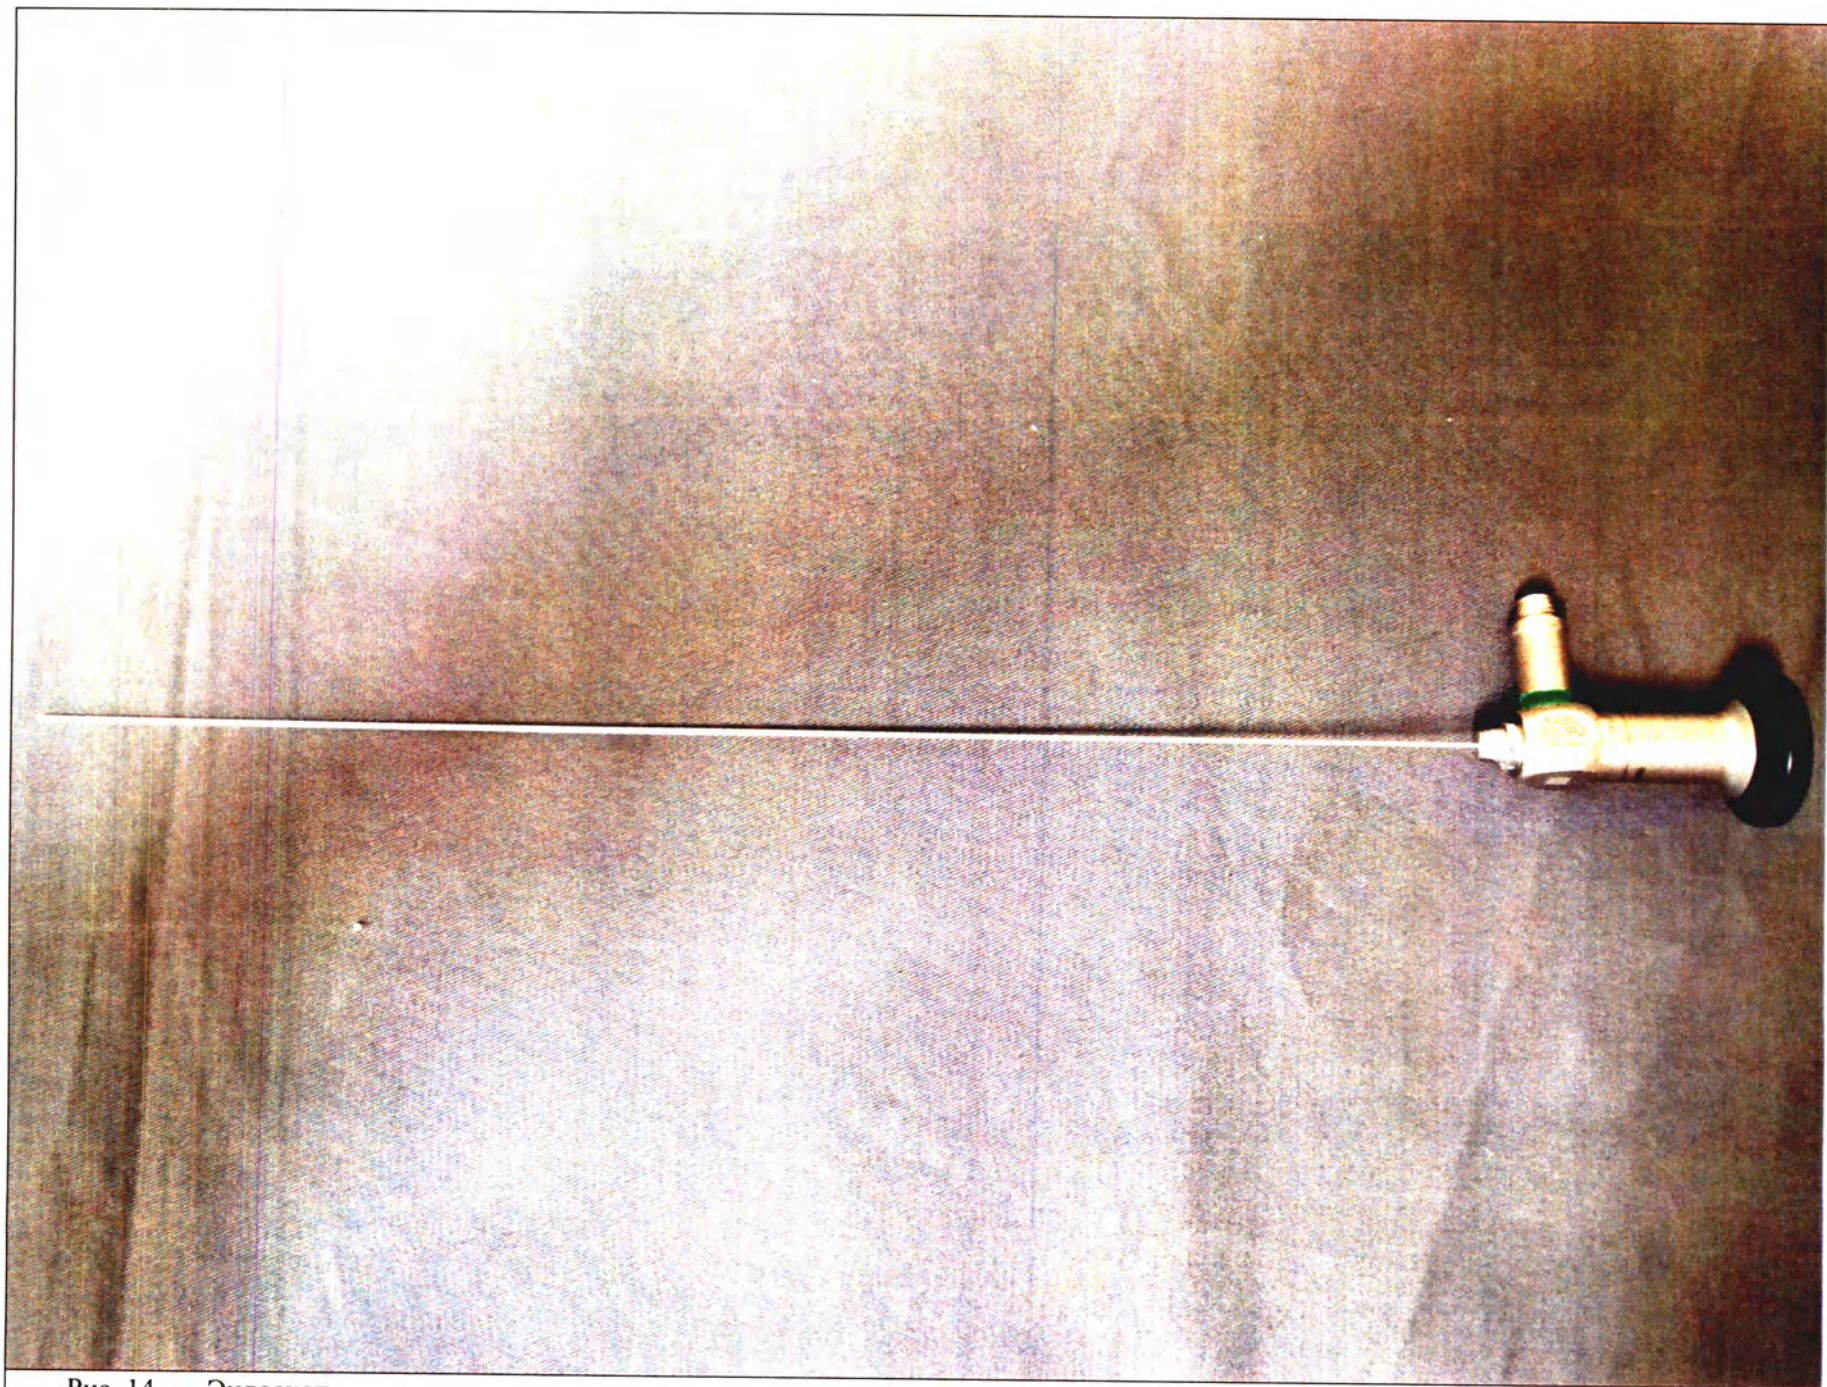


Рис. 14. Эндоскоп

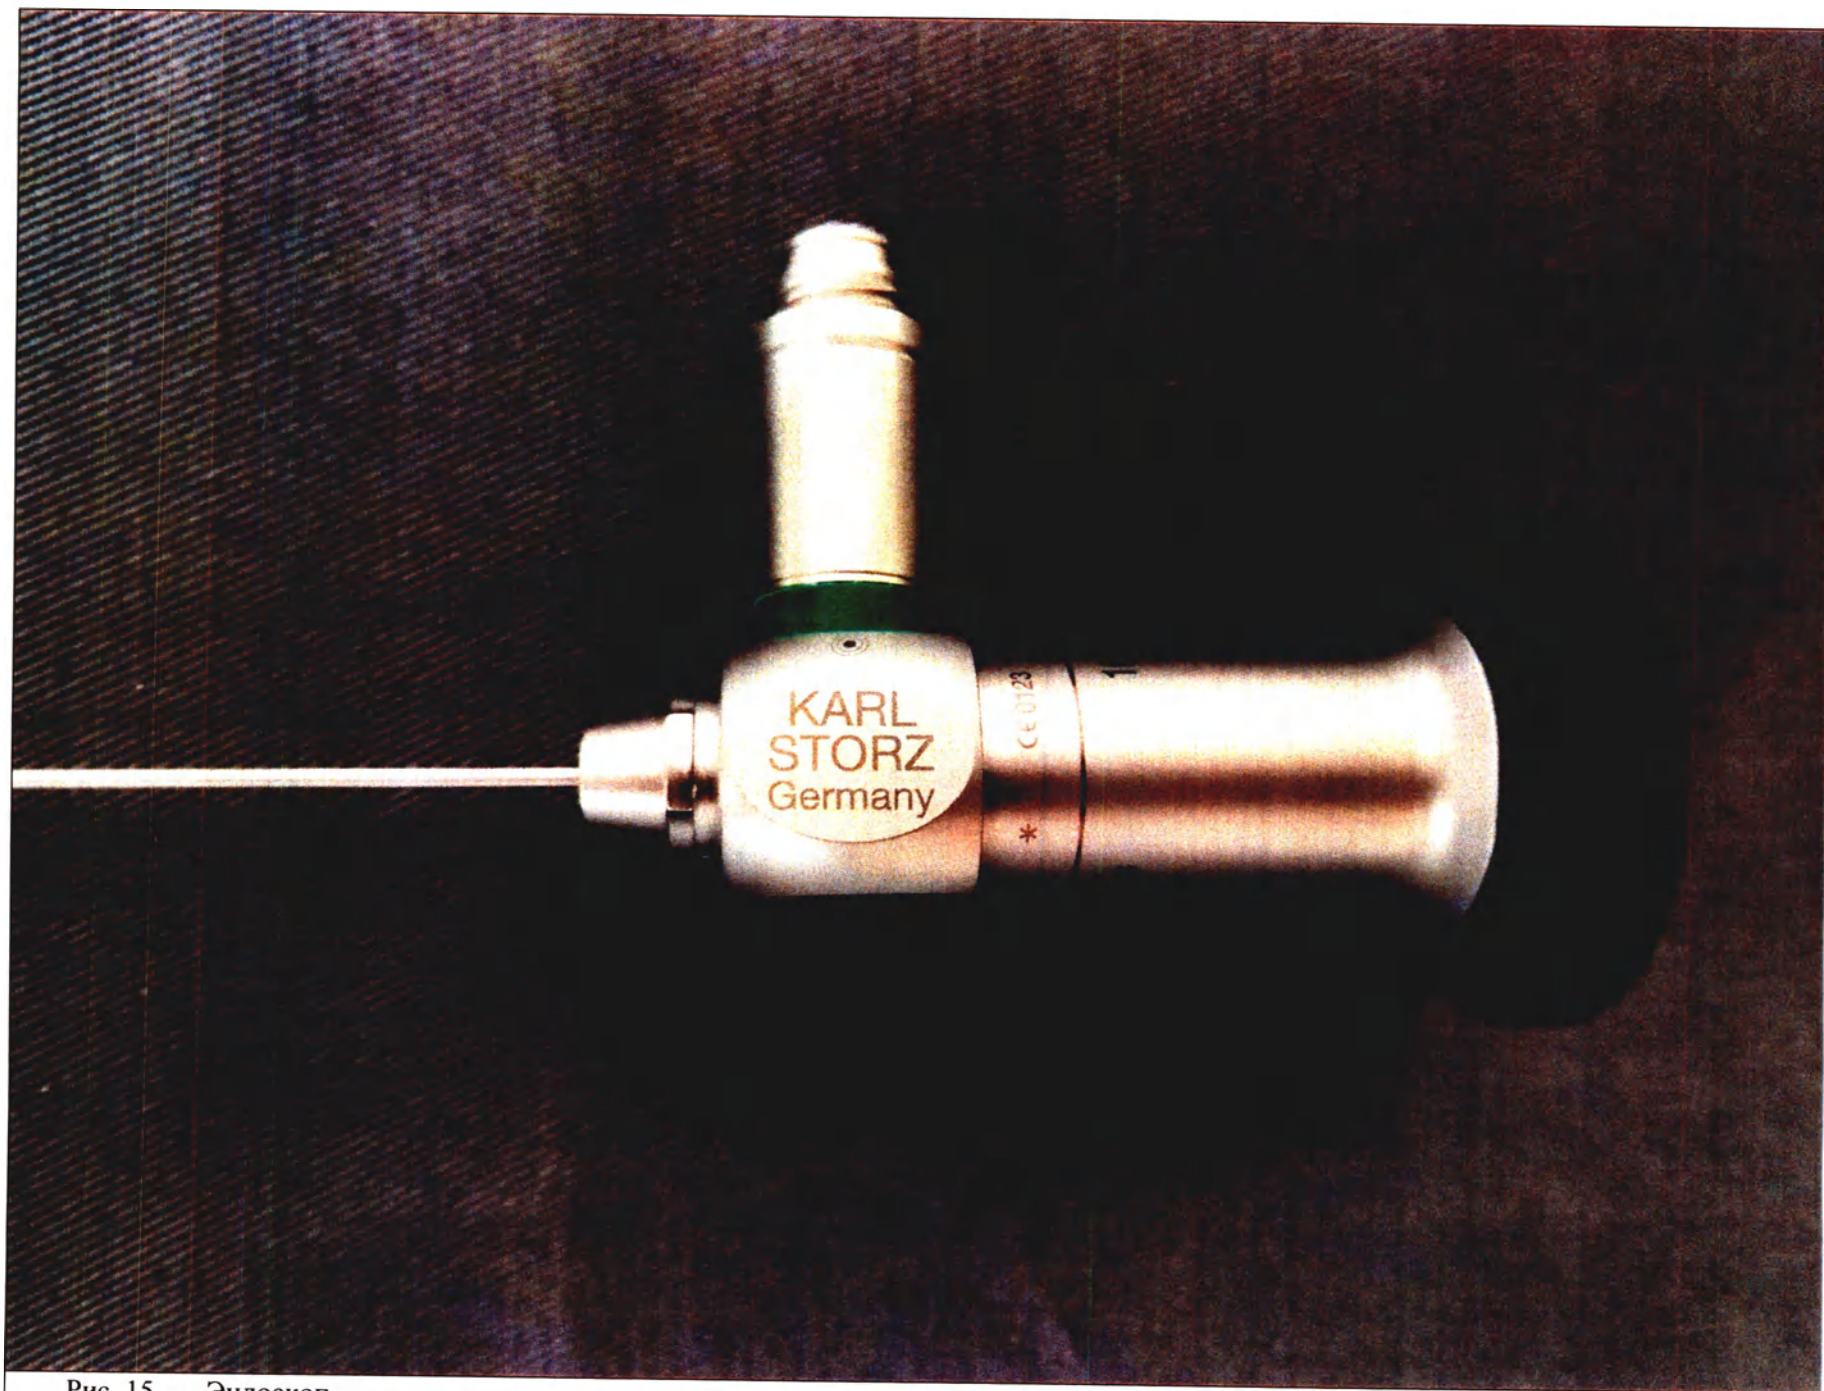


Рис. 15. Эндоскоп

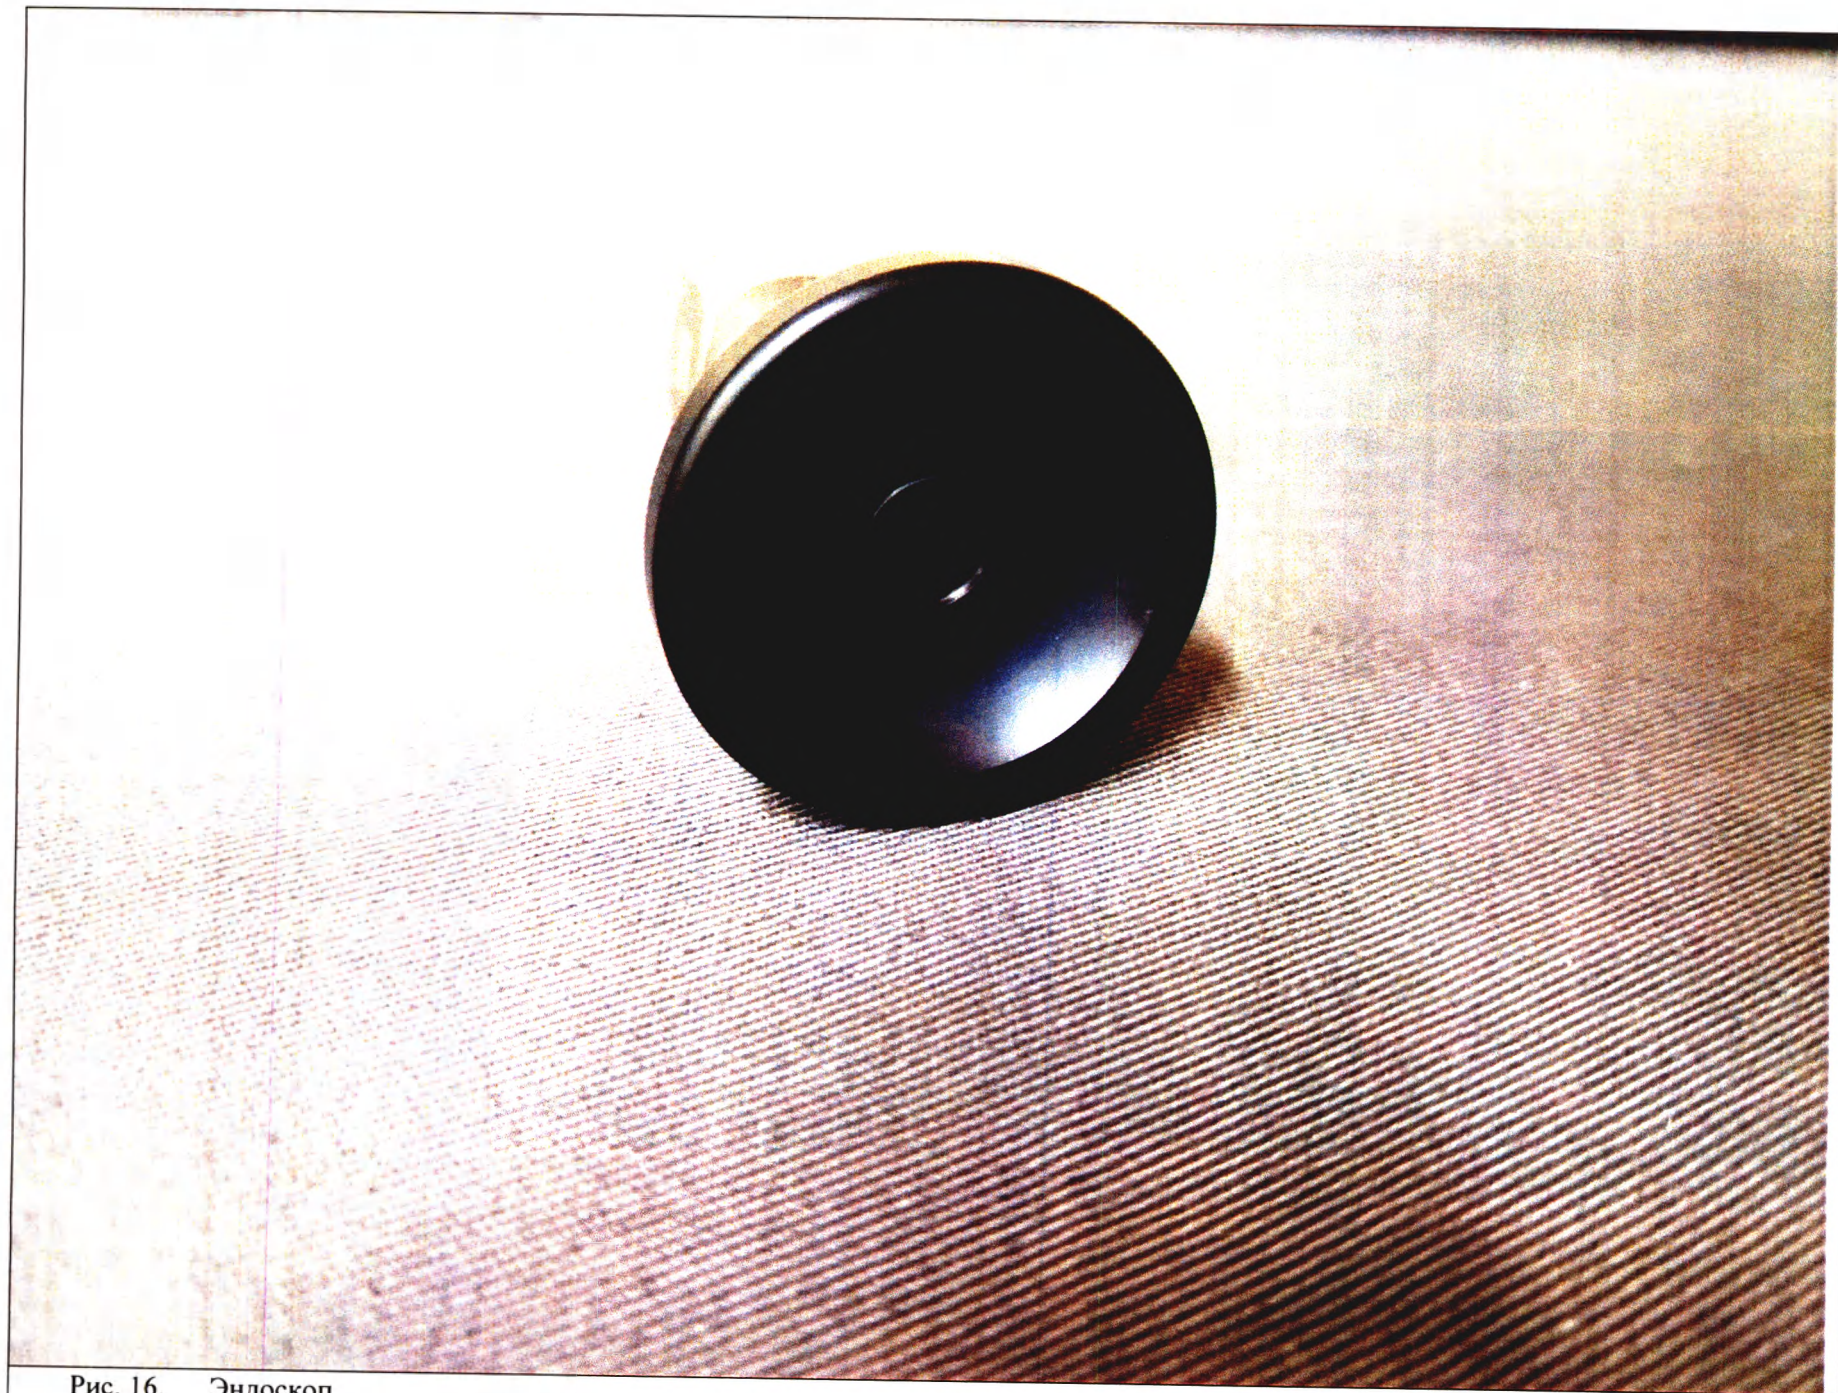


Рис. 16. Эндоскоп



Рис. 17. Эндоскоп



Рис. 18. Эндоскоп



Рис. 19. Эндоскоп

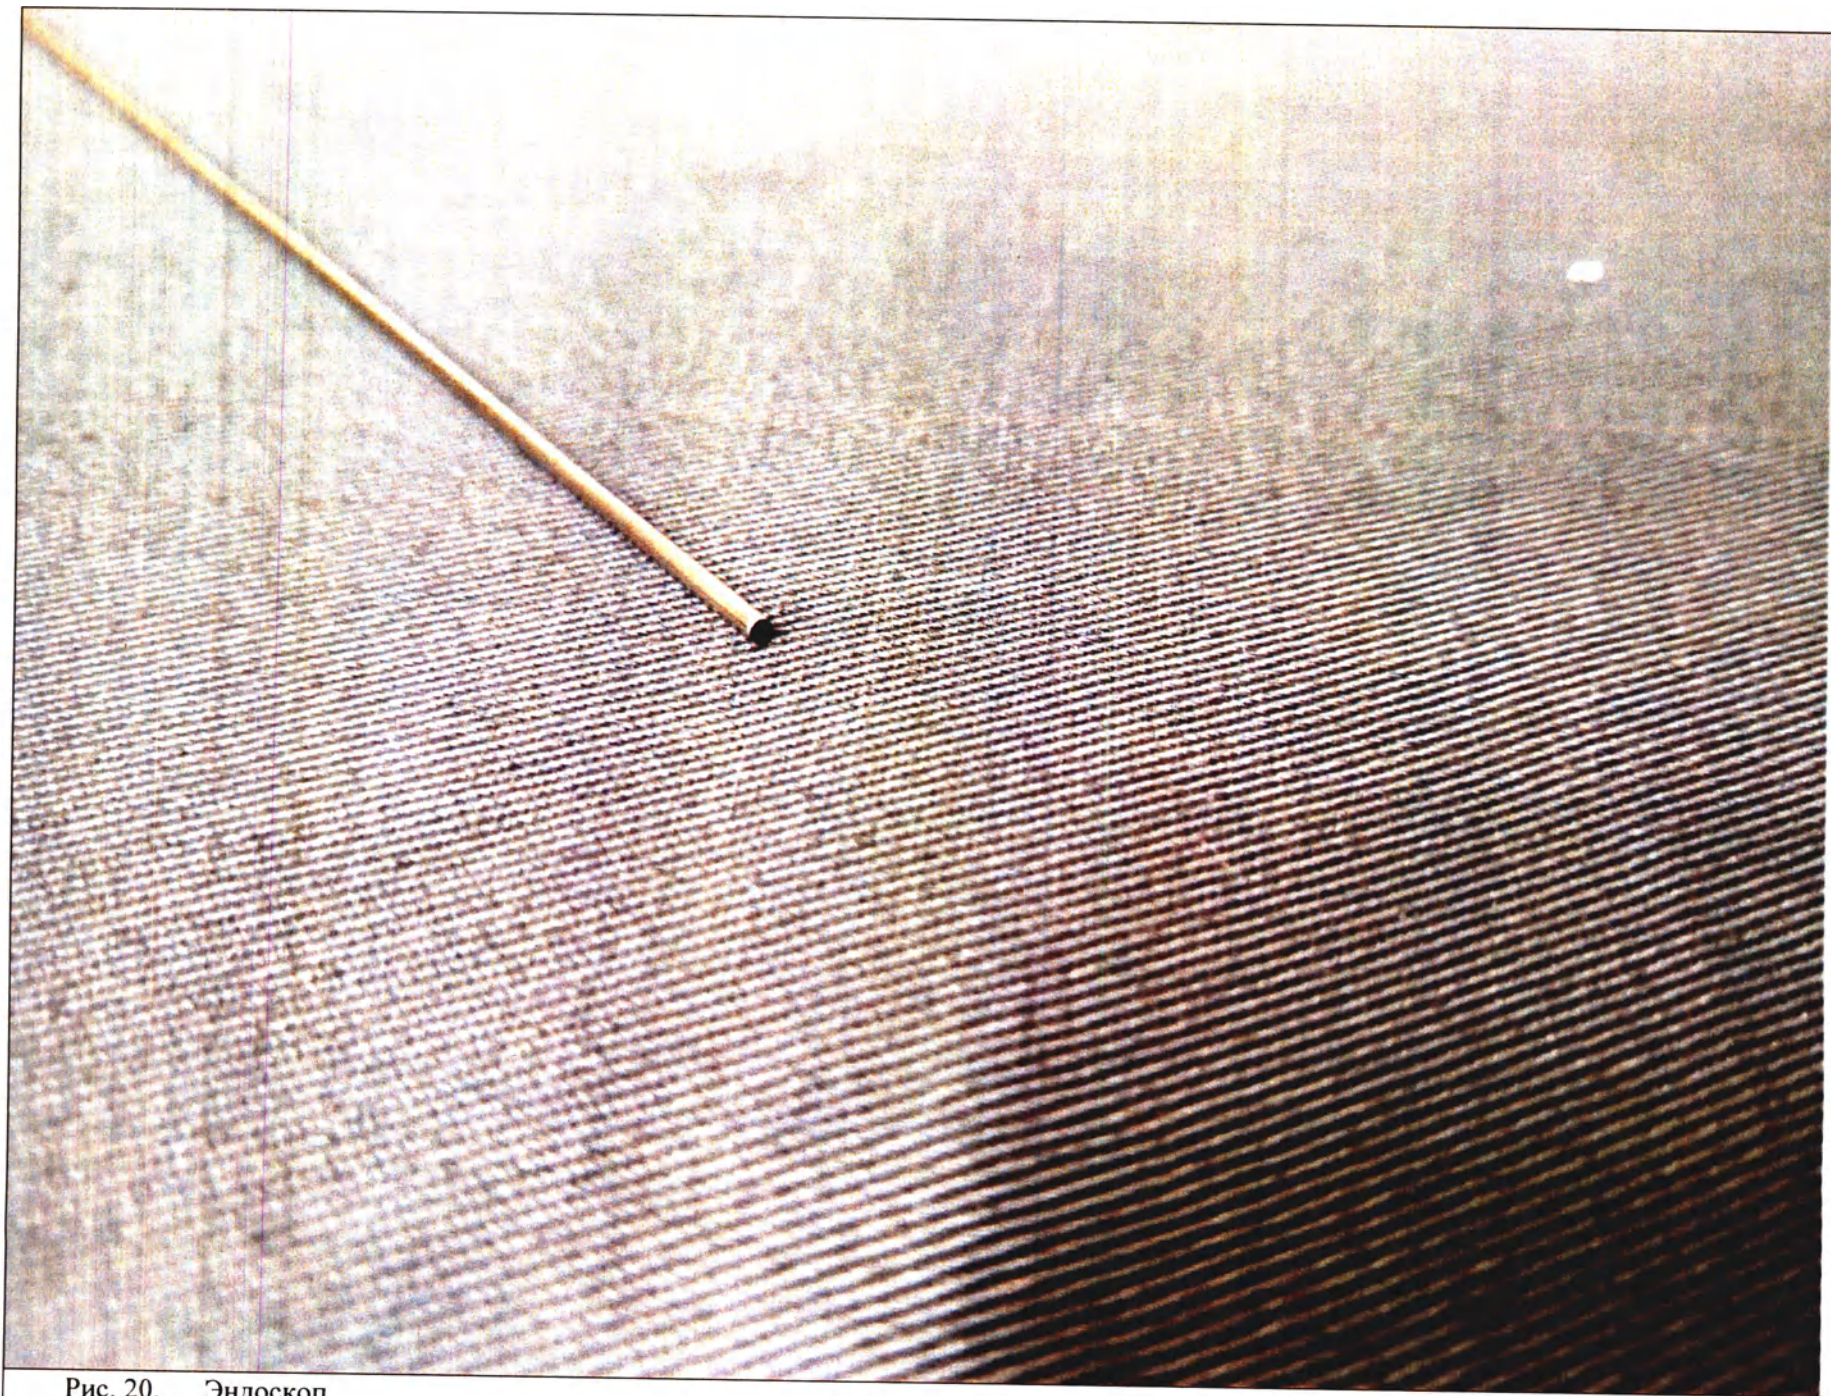


Рис. 20. Эндоскоп



Рис. 21. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см

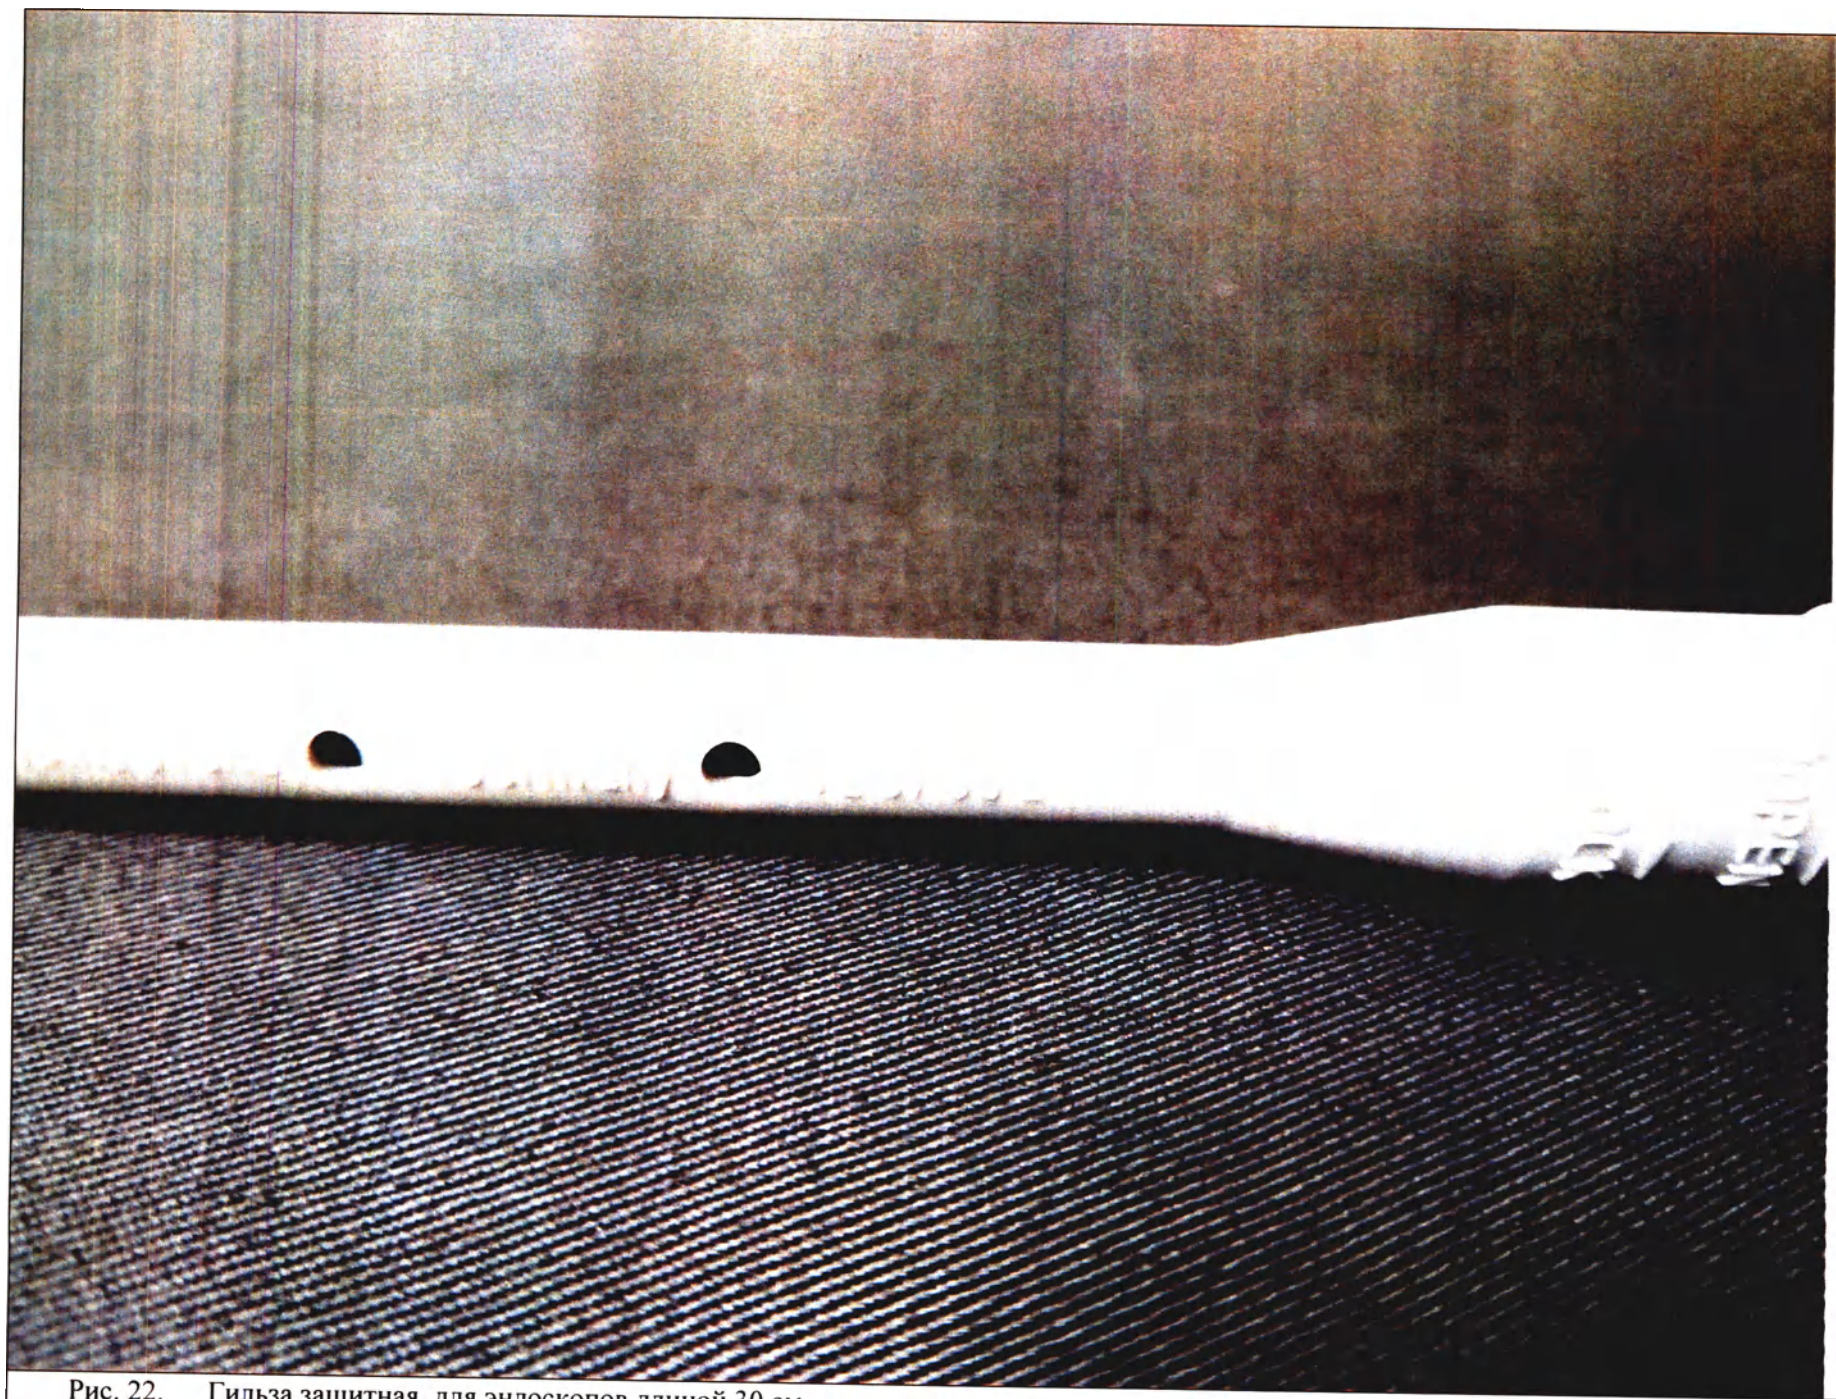


Рис. 22. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см



Рис. 23. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см

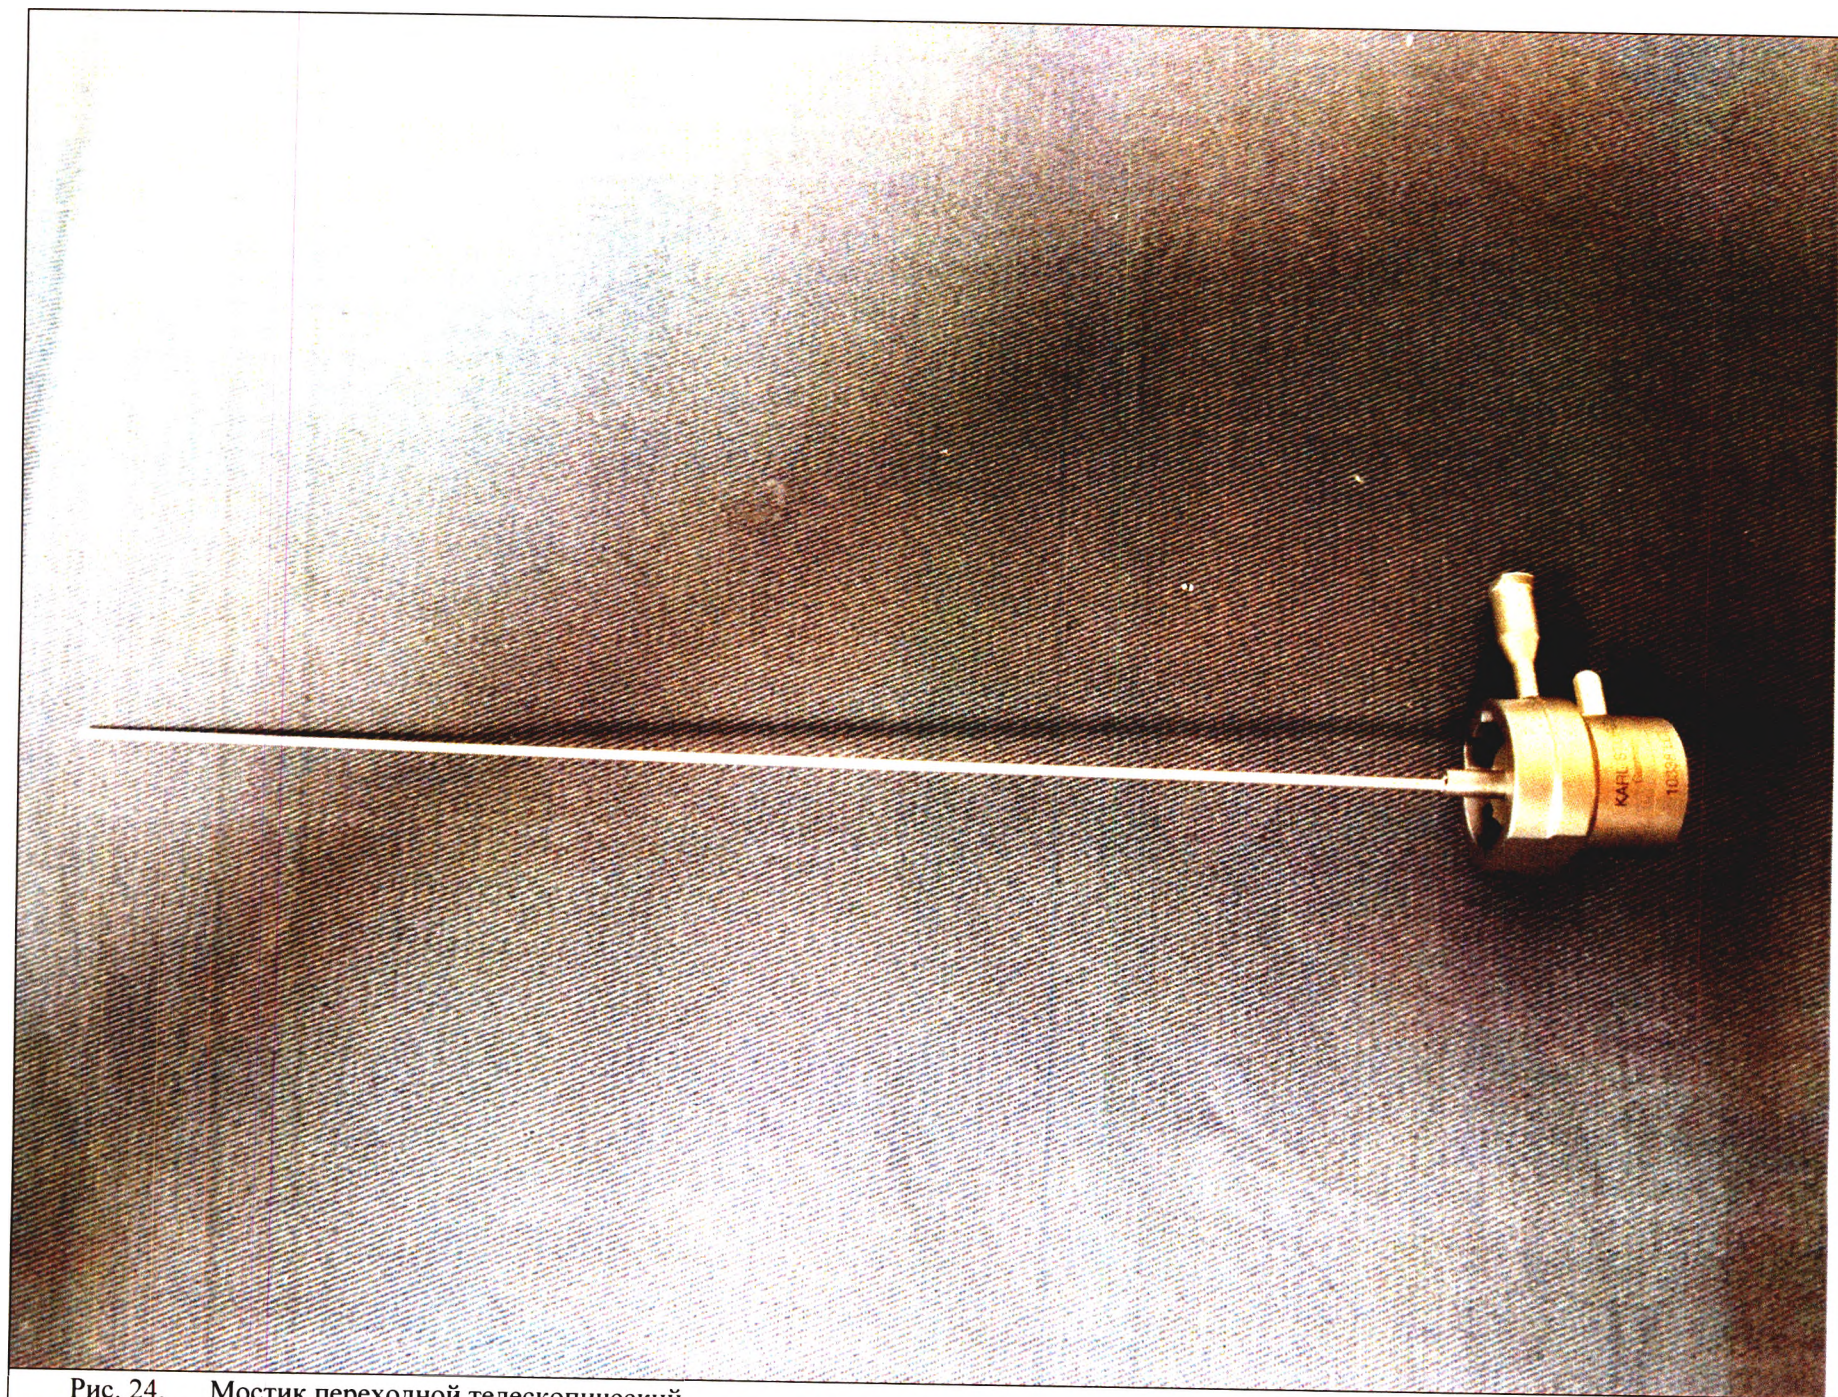


Рис. 24. Мостик переходной телескопический

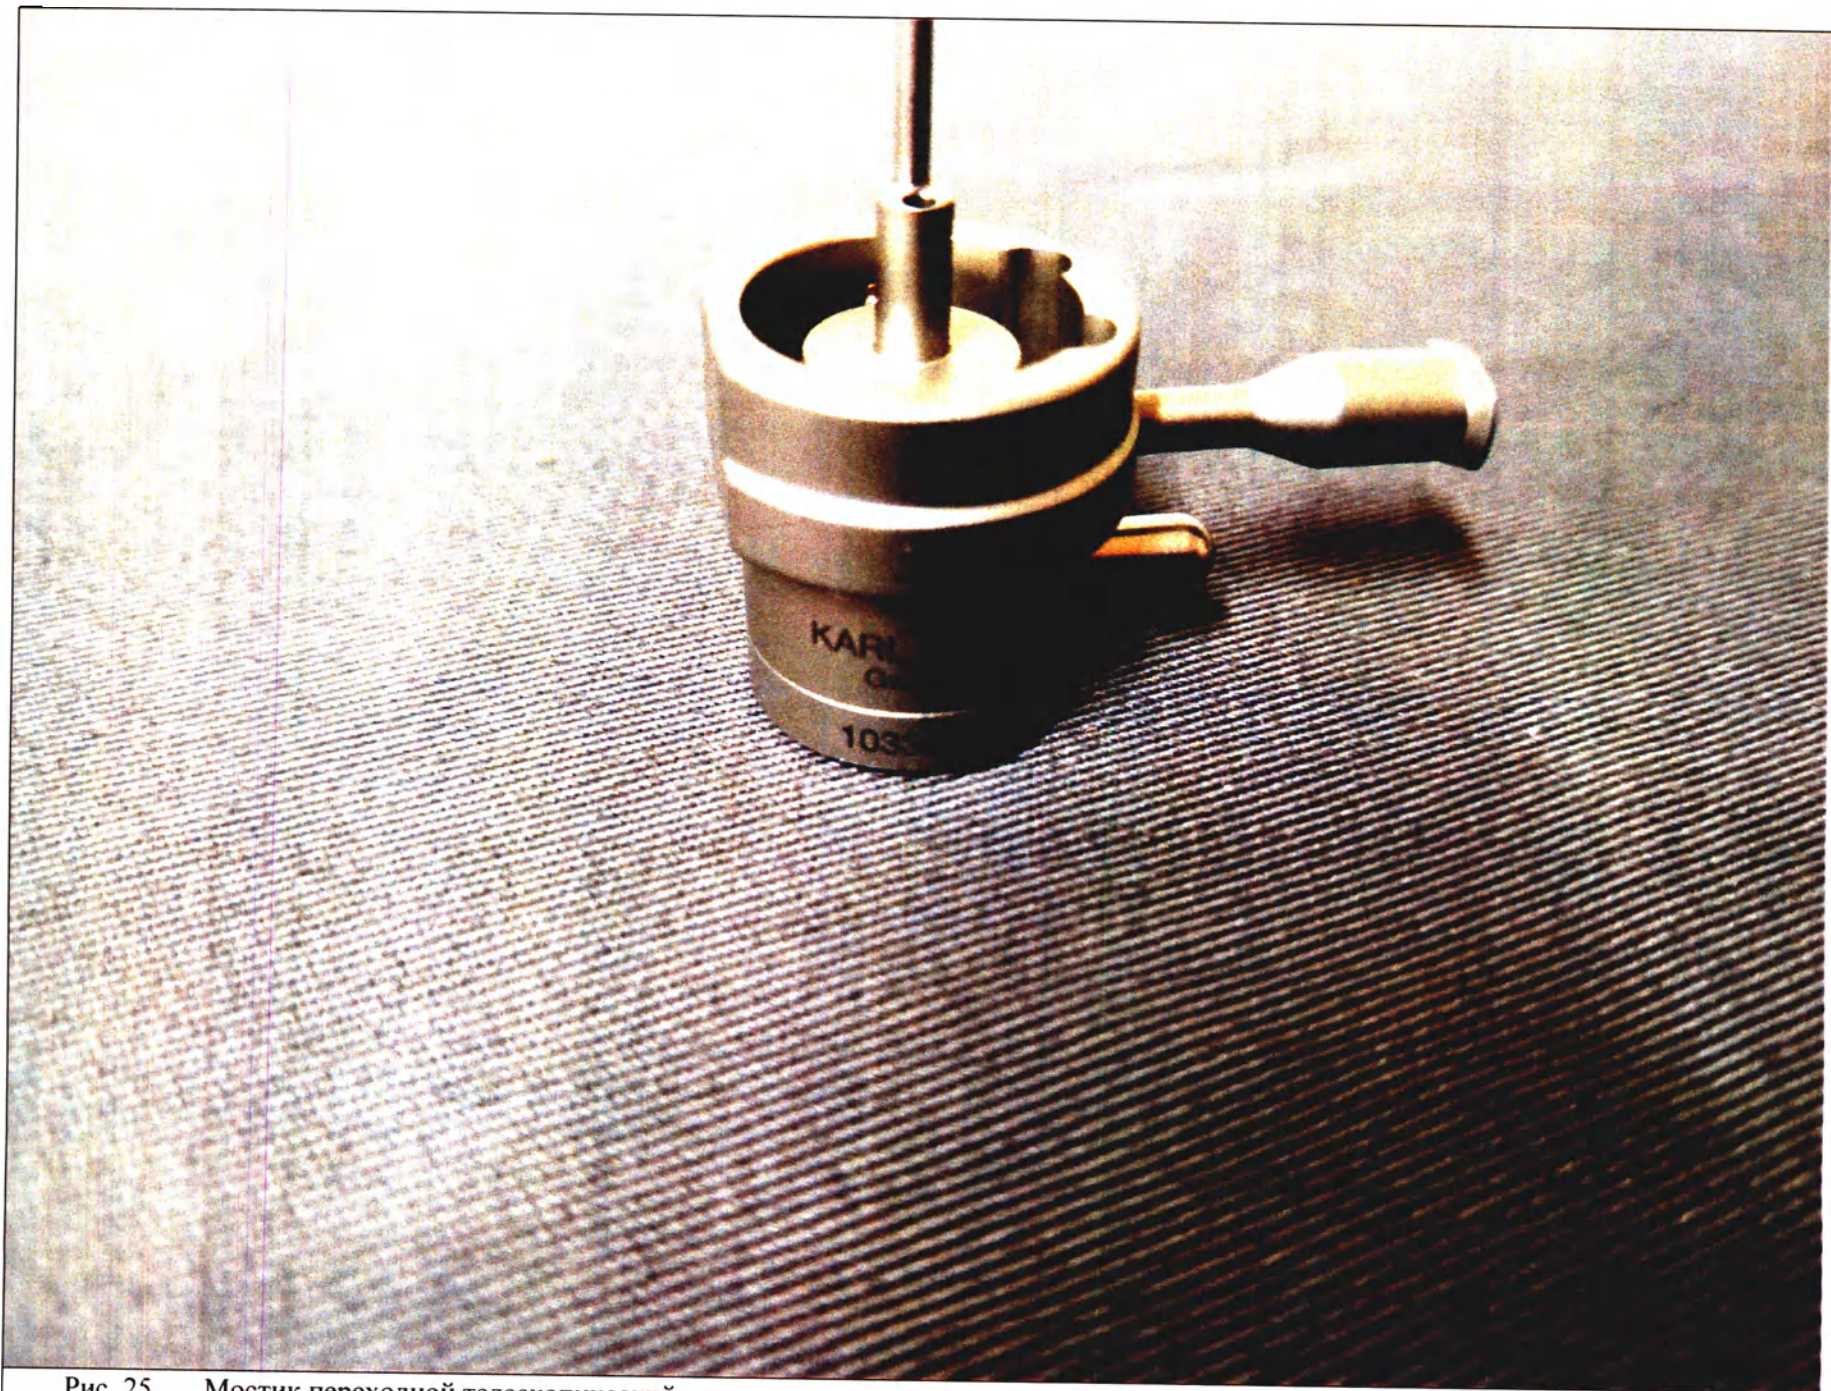


Рис. 25. Мостик переходной телескопический

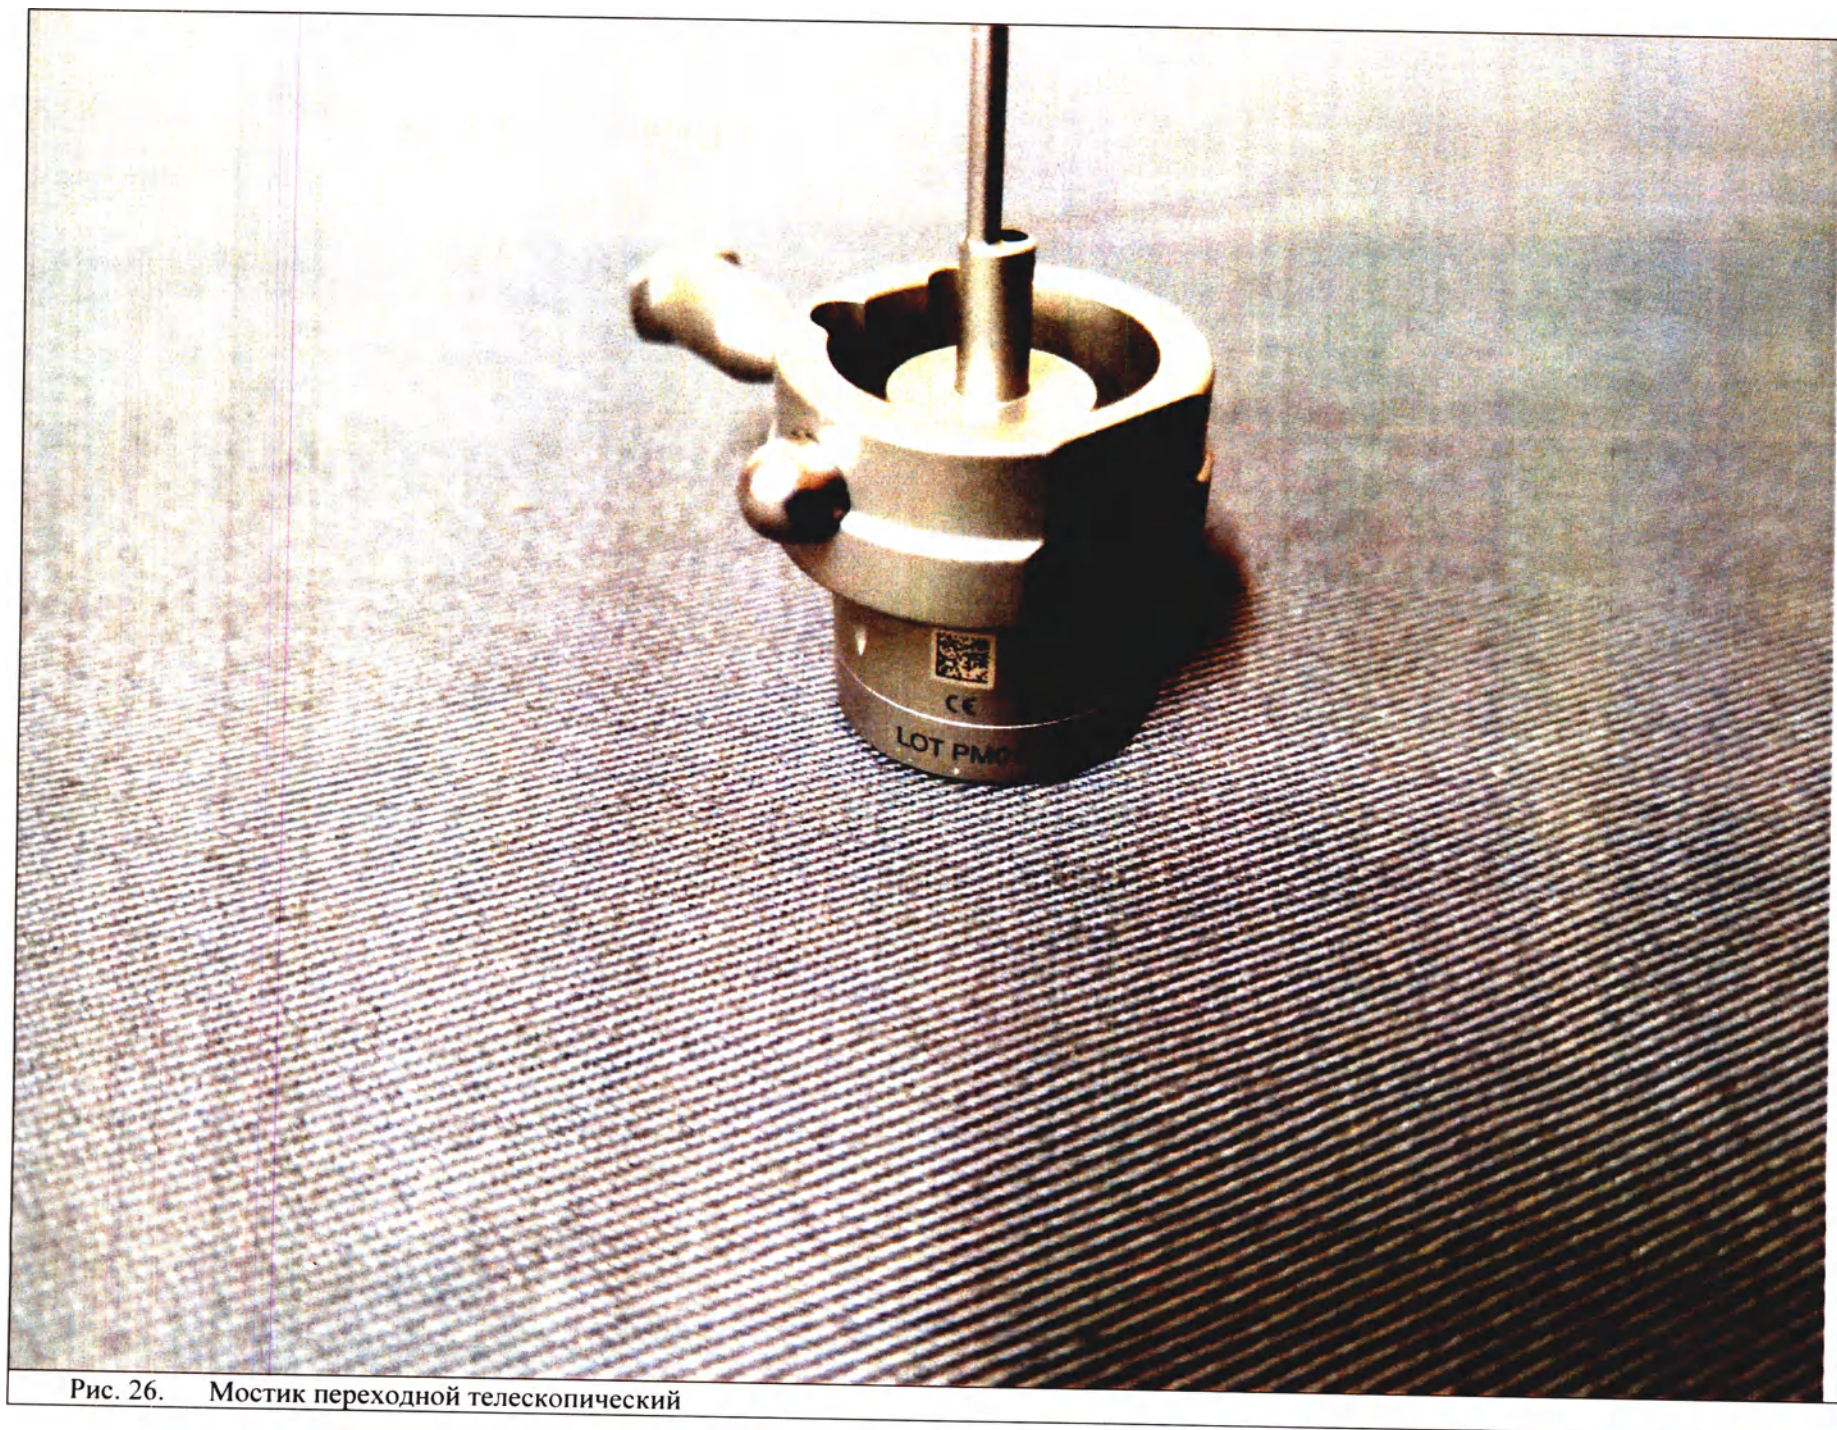


Рис. 26. Мостик переходной телескопический

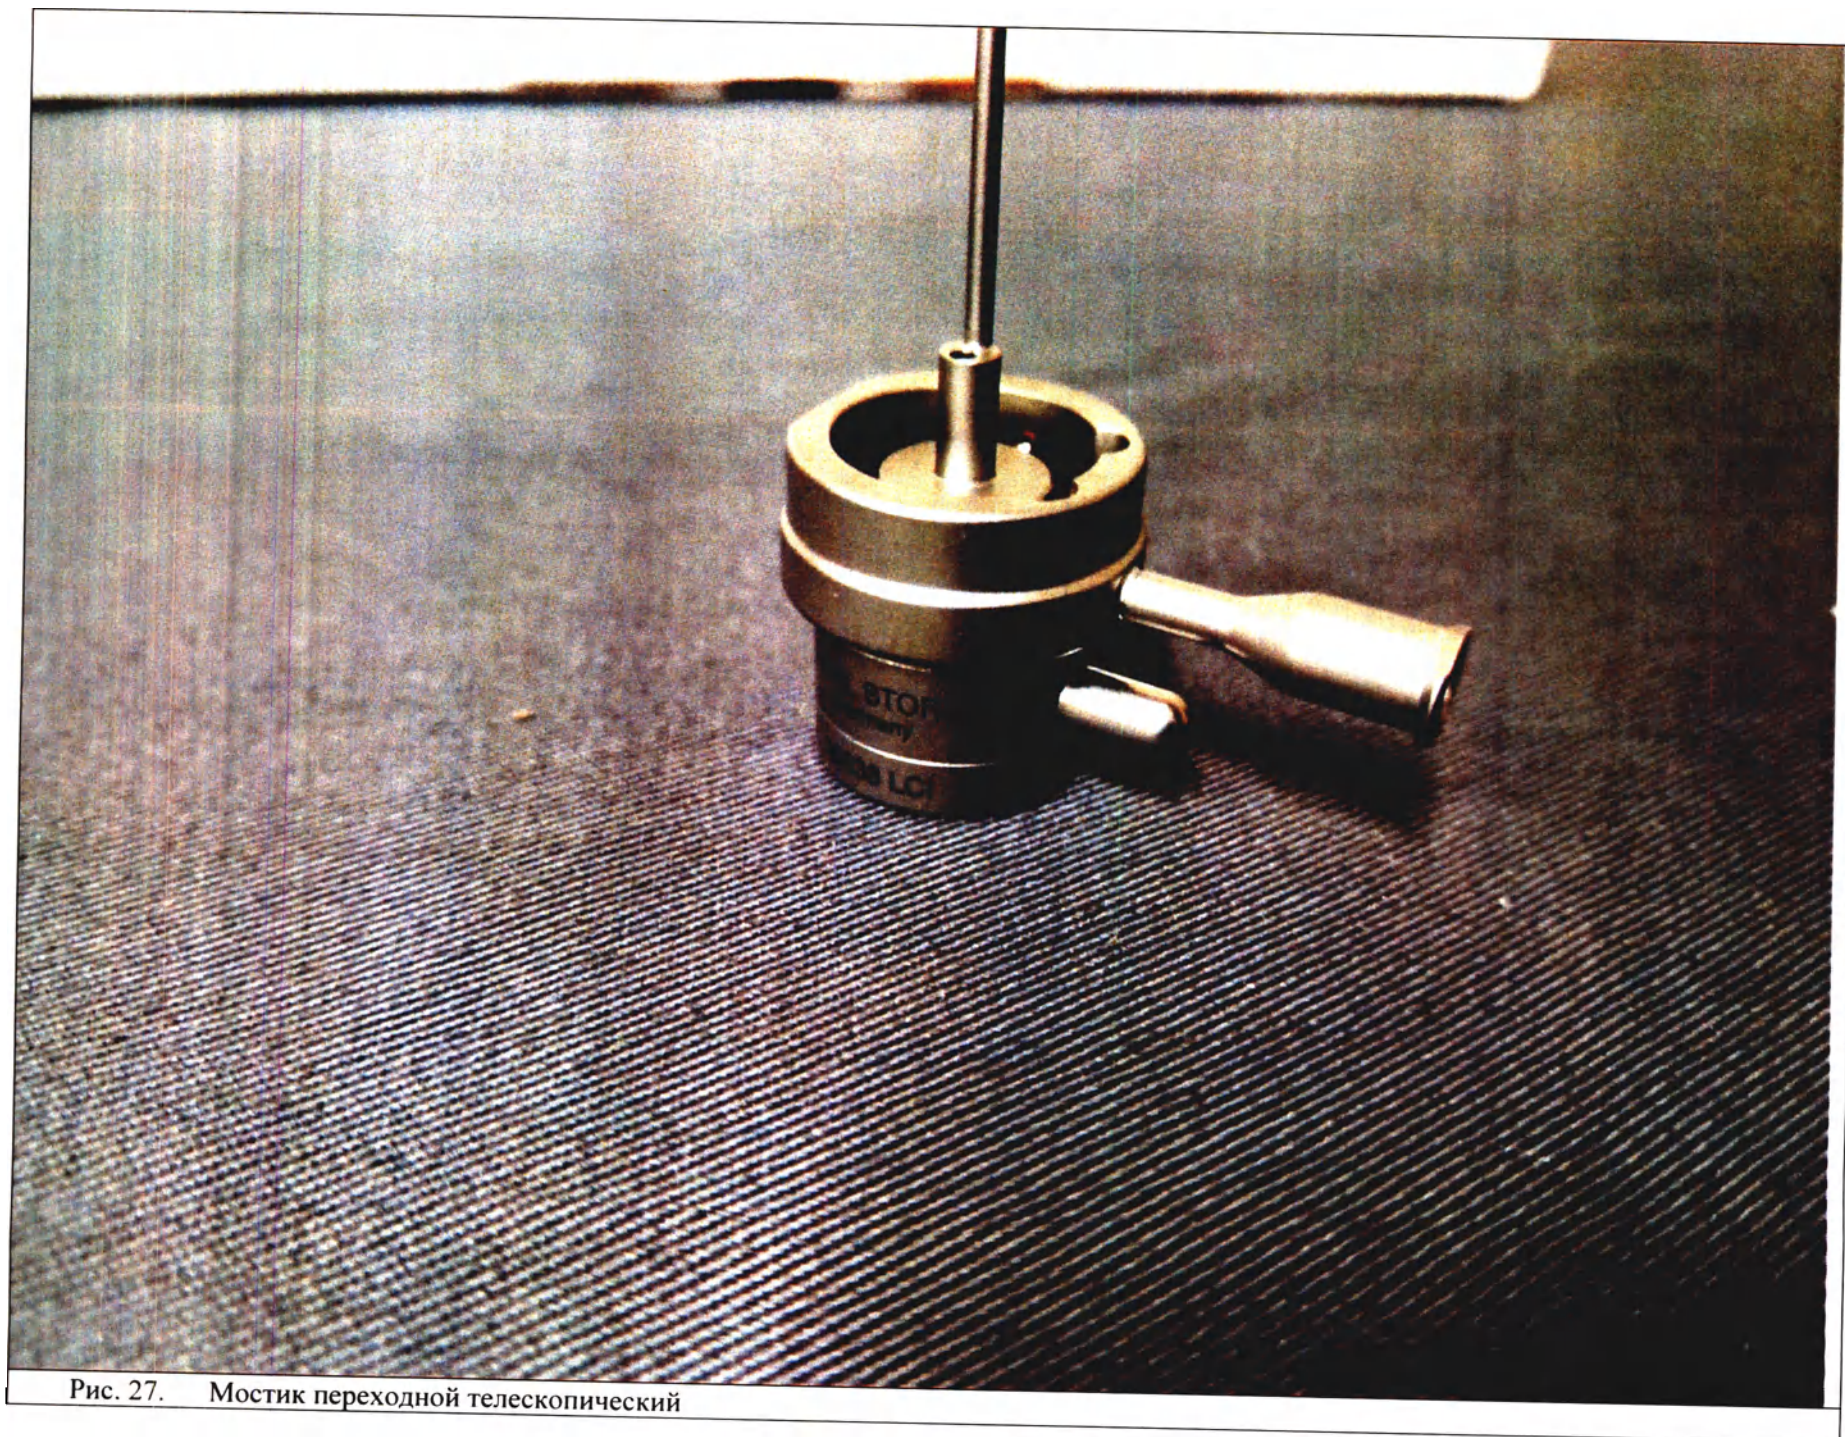


Рис. 27. Мостик переходной телескопический

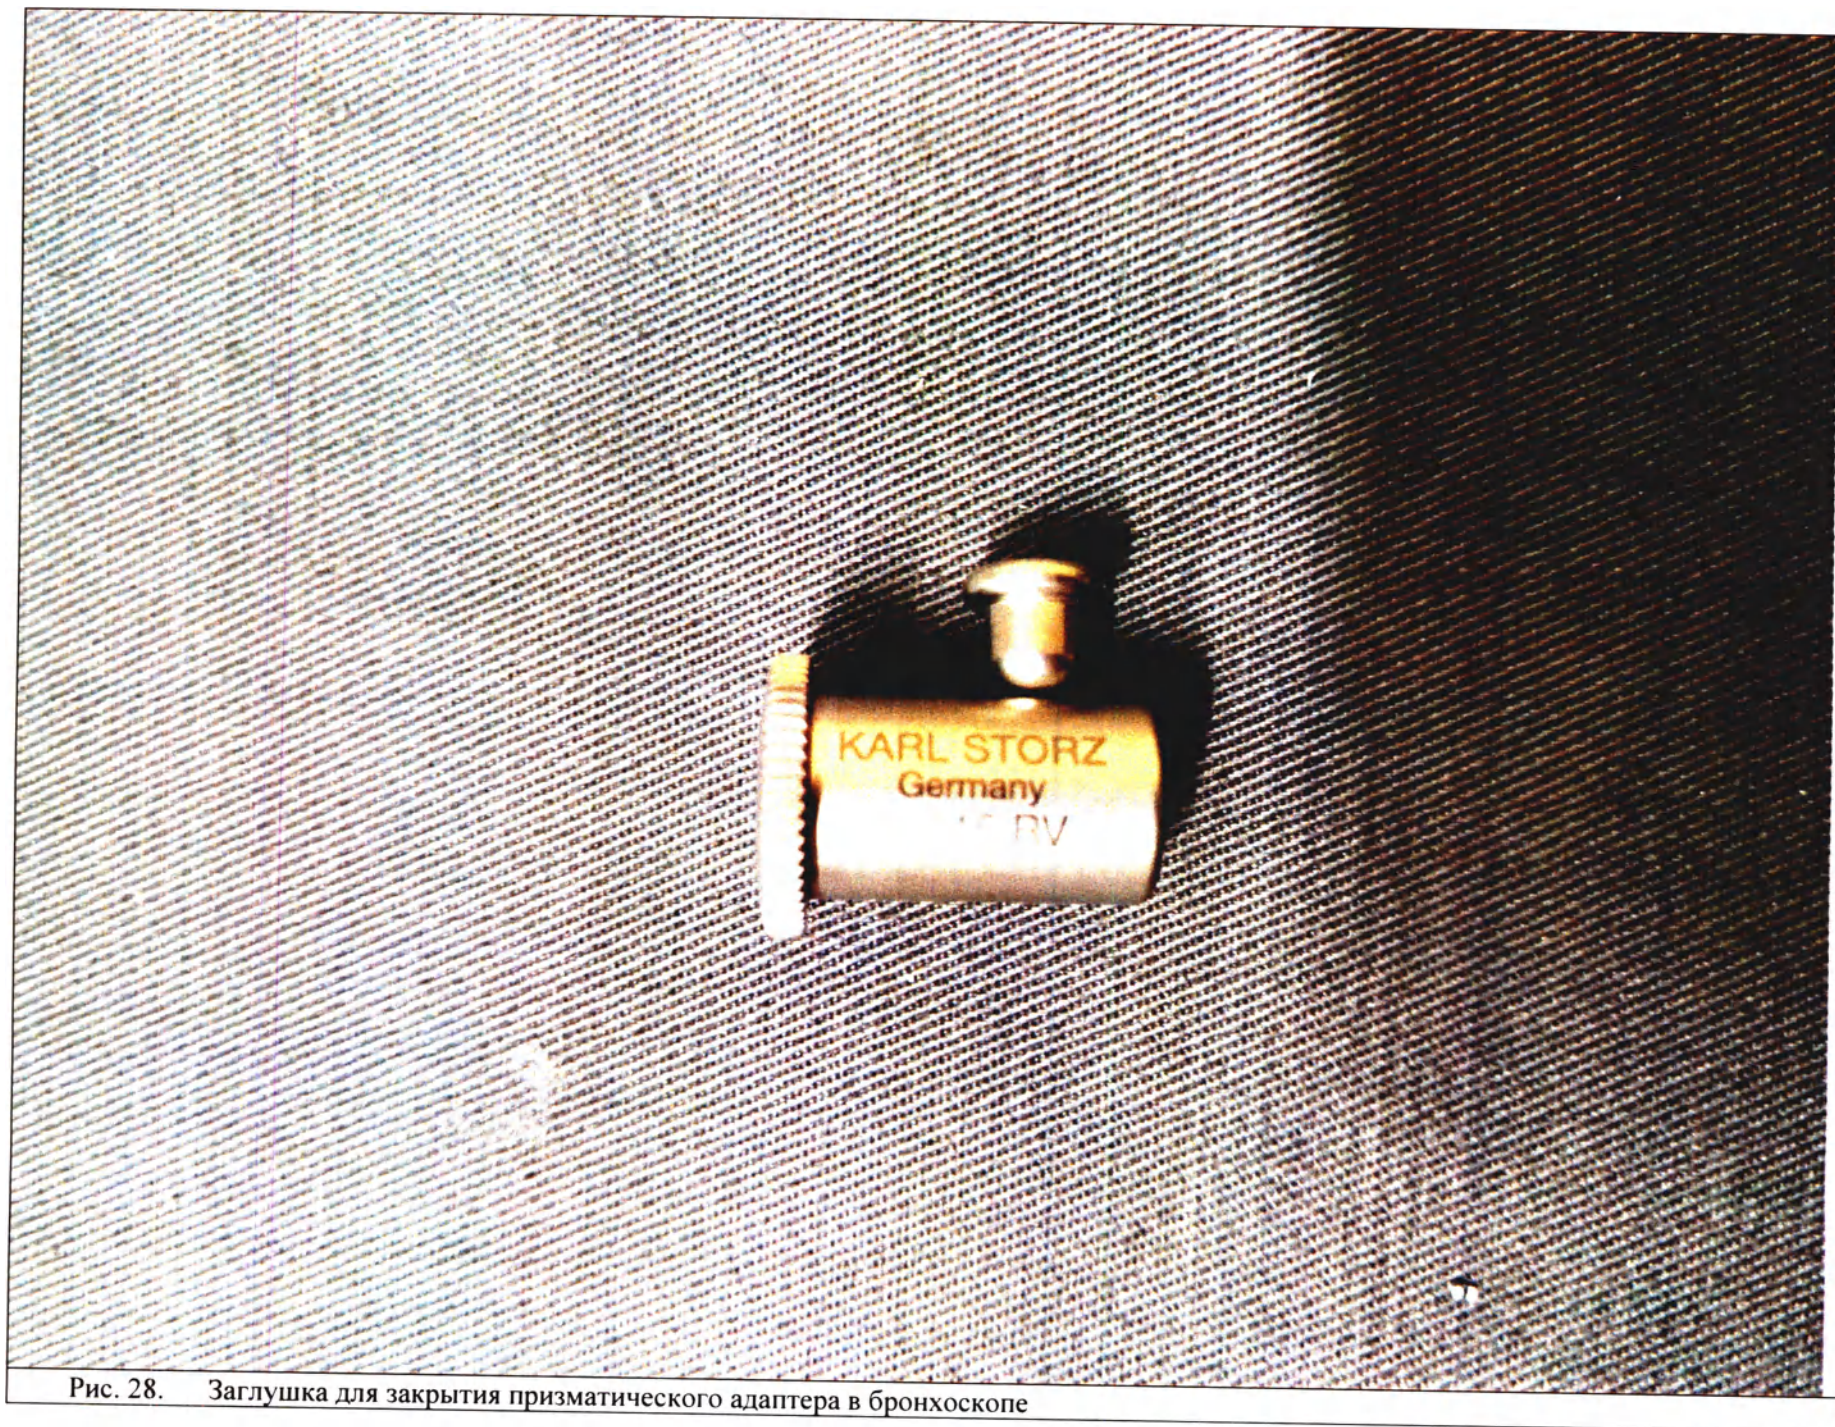


Рис. 28. Заглушка для закрытия призматического адаптера в бронхоскопе



Рис. 29. Заглушка для закрытия призматического адаптера в бронхоскопе



Рис. 30. Упаковка на примере: Бронхоскоп жесткий миниатюрный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 30,6 см



Рис. 31. Упаковка на примере: Бронхоскоп жесткий миниатюрный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 30,6 см

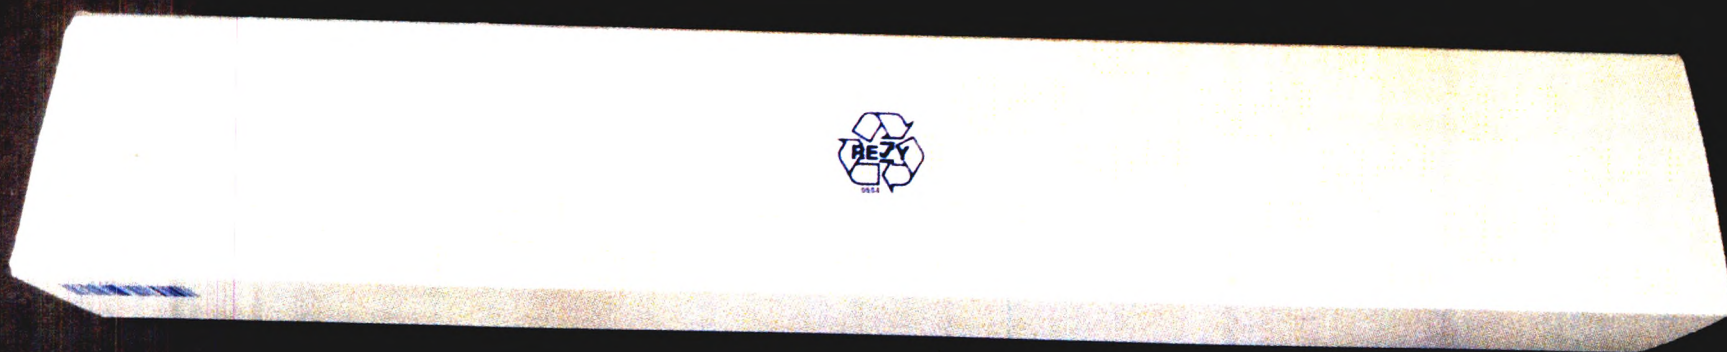


Рис. 32. Вторичная упаковка на примере: Бронхоскоп жесткий миниатюрный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 18,8 см. в составе

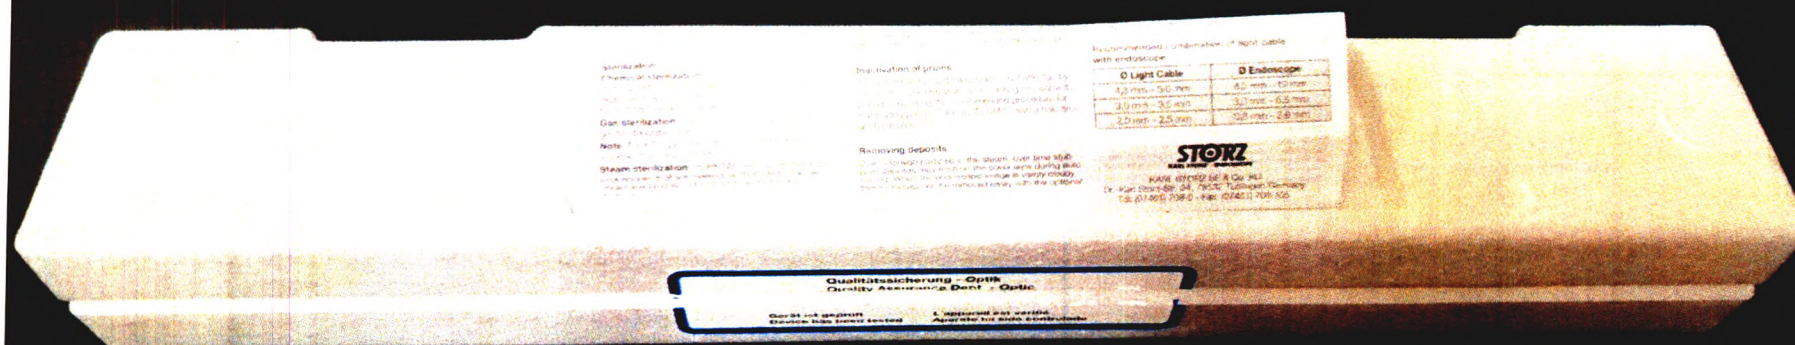


Рис. 33. Первичная упаковка на примере: Бронхоскоп жесткий миниатюрный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 18,8 см, в составе

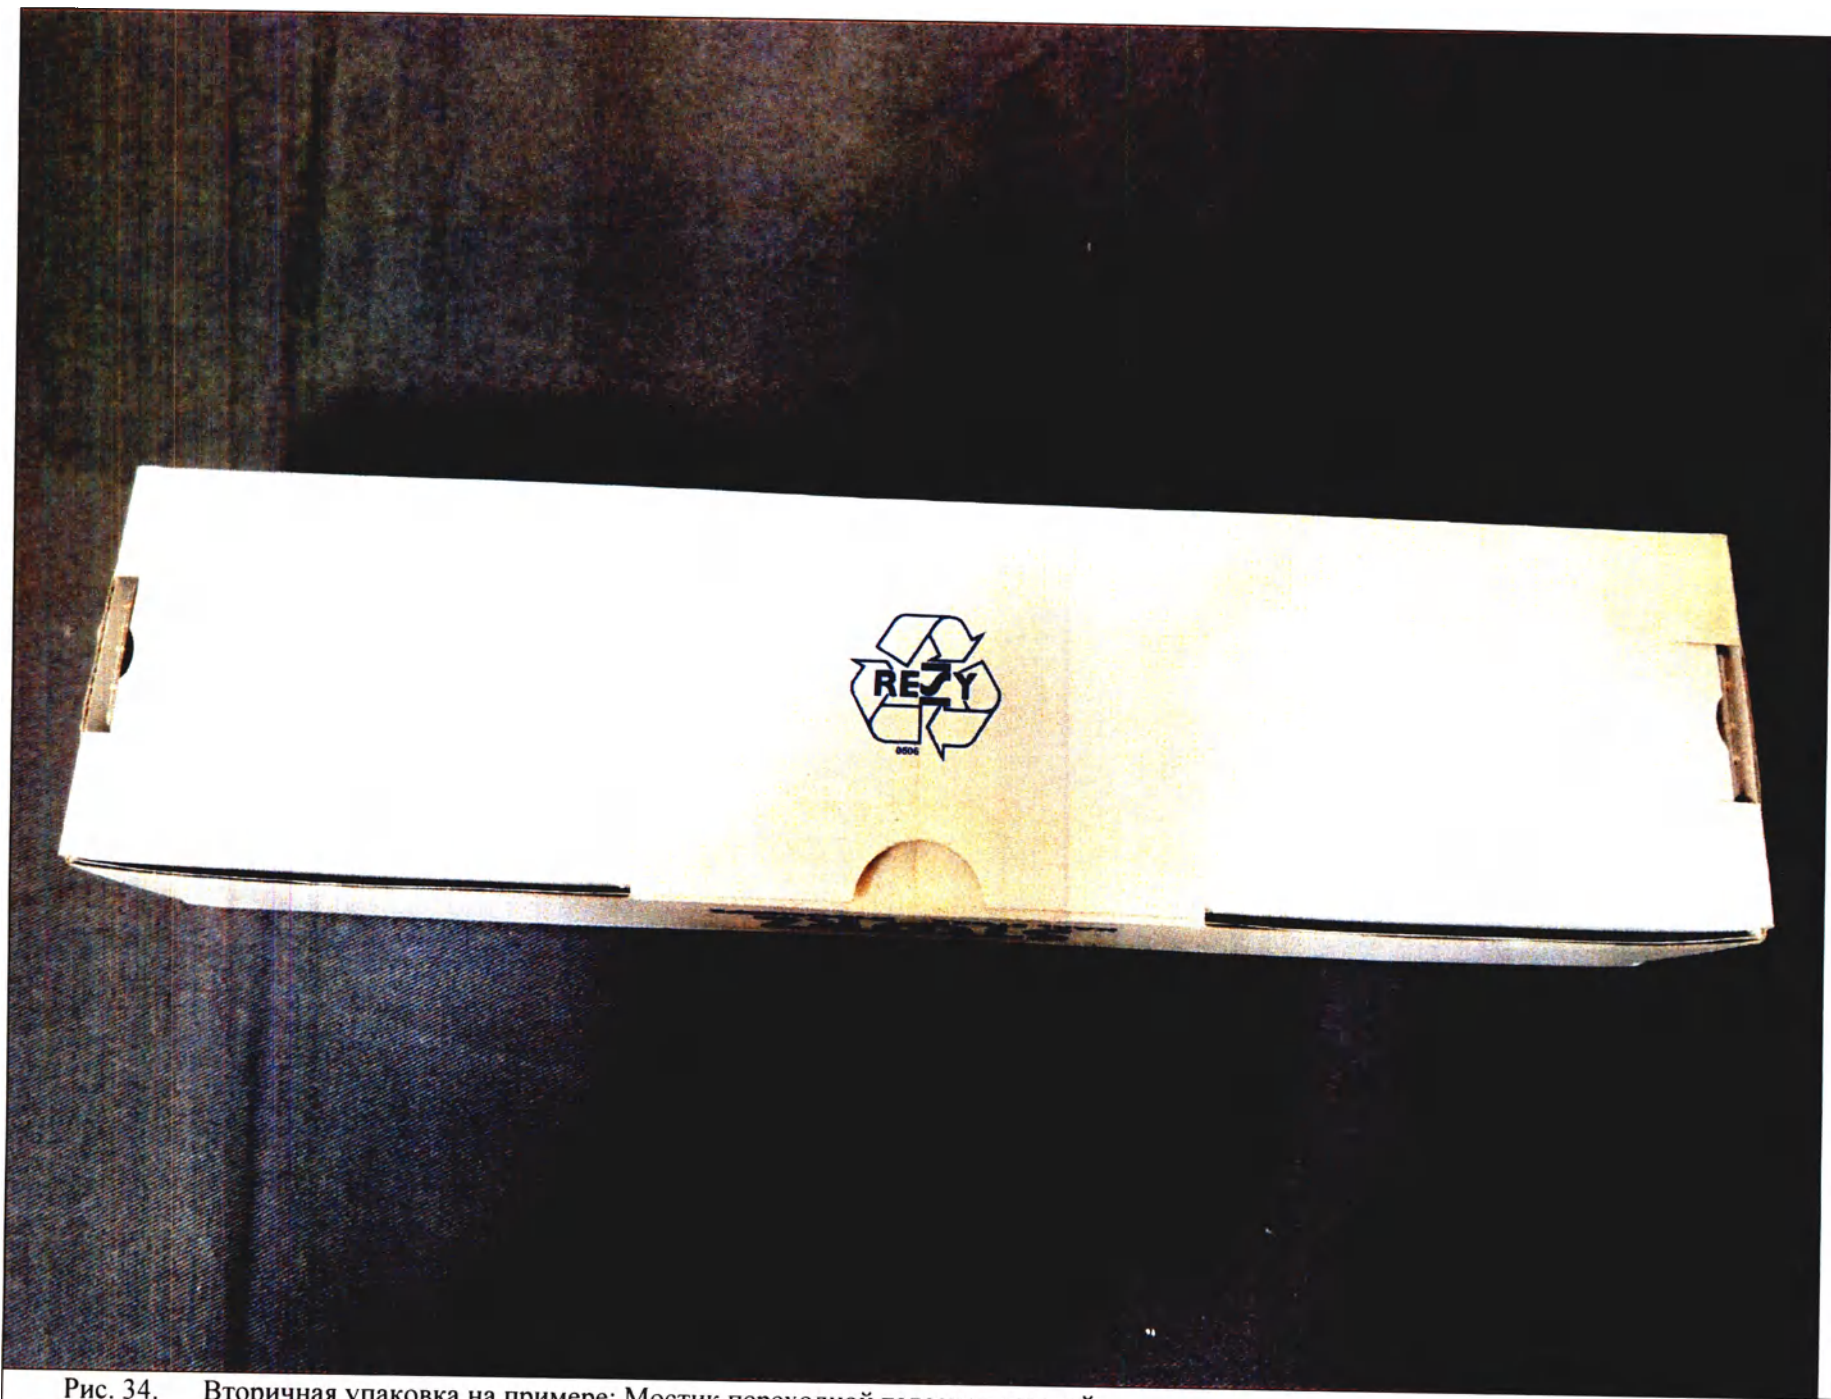


Рис. 34. Вторичная упаковка на примере: Мостик переходной телескопический

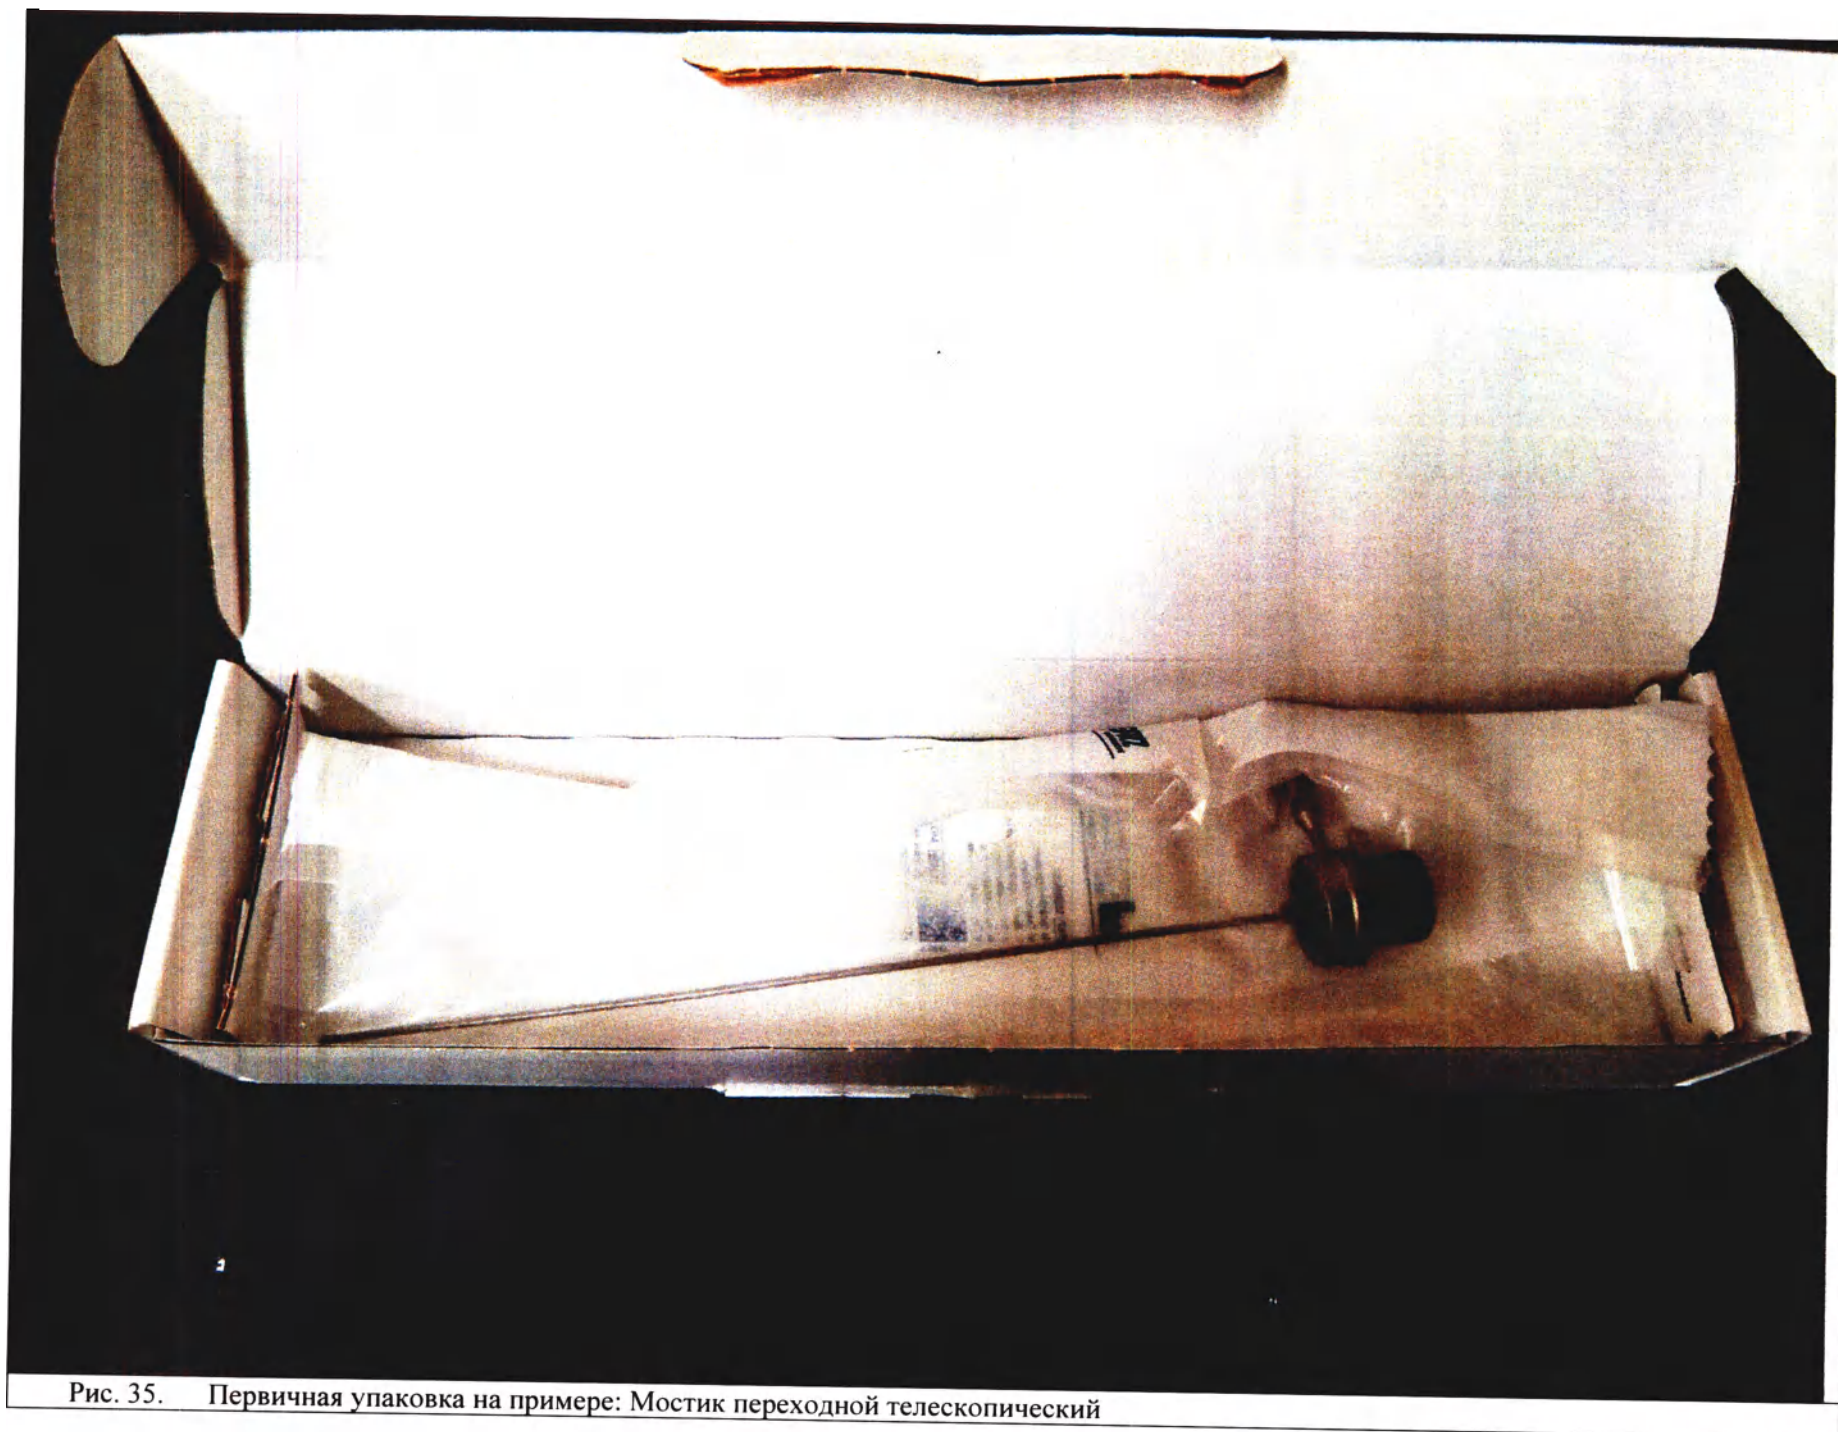


Рис. 35. Первичная упаковка на примере: Мостик переходной телескопический



Рис. 36. Первичная упаковка на примере: Мостик переходной телескопический

 KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

REF 10315RV

de Blindstopfen
en Blanking Plug
fr Bouchon aveugle
it Arresto filettato
es Tapa ciego
pt Bujão

LOT PM01
QTY 1



020002

Rx only MD 2023-03-31

 www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)0404855 1045510(11)231031102PM01(422)276

CE

Рис. 37. Первичная упаковка на примере: заглушка для закрытия призматического адаптера в бронхоскопе



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF 10040AA

SN 4089187

QTY 1

Miniatur-Geradeausblick-Optik 0°, 1,3mm

Mini Straight Forward Scope 0°, 1,3mm

Optique miniat. vision directe 0°, 1,3mm

Sistema ottico miniaturizzato 0°, 1,3mm

Óptica mini. visión frontal 0°, 1,3 mm

Ótica mini. de visão frontal 0°, 1,3 mm



RxONLY

07104048551220808(240)10040AA(21)4089187

CE 0123



Рис. 38. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF 10338LCI

LOT PM01

QTY 1

de Optikführungskappe
en Telescope Bridge
fr Bouchon-guide pour optique
it Tappo guida p.sist.ott.
es Tapa guía para óptica
pt Tampa-guia para ótica



U2000Z

Rx only

MD



2023-03-30



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551320702(11)230330(10)PM01(422)278



Рис. 39. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

REF 10338LCI

de Optikführungskappe
en Telescope Bridge
fr: Bouchon-guide pour optique
it Tappo guida p.sist.ott.
es Tapa guía para óptica
pt Tampa-guia para ótica

LOT PM01

QTY 1

020002



Rx only

MD



2023-03-30

UDI (G1) 04048551320752

www.karlstorz.com/ifu

CPM01 422 200



Рис. 40. Пример маркировки на упаковке

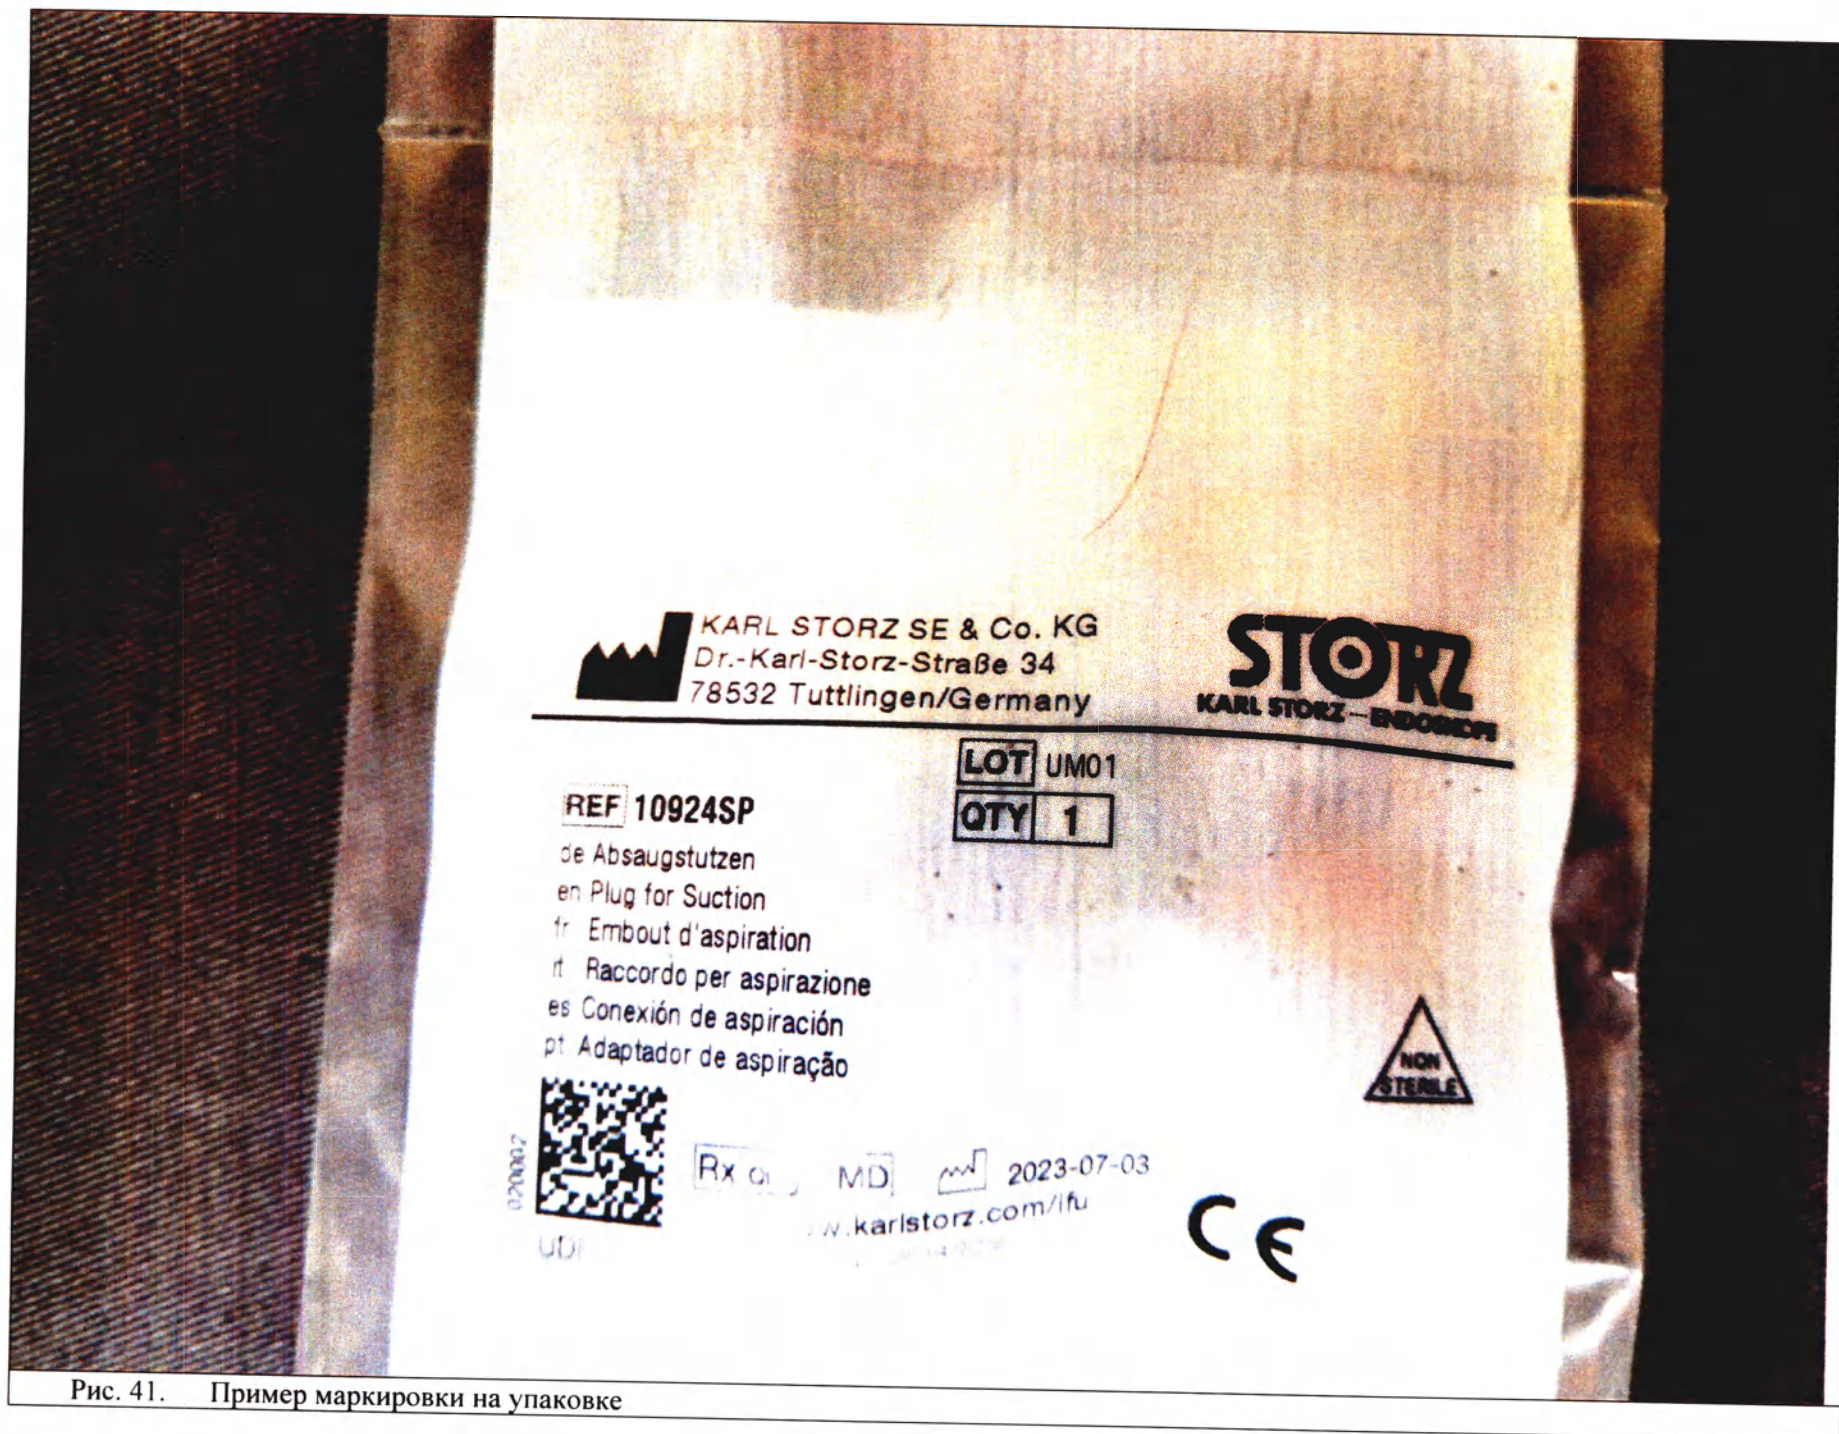


Рис. 41. Пример маркировки на упаковке

**Инструкция по эксплуатации
«Бронхоскоп жесткий миниатюрный, в вариантах исполнения, с принадлежностями»**

**Instructions for use
«Bronchoscope rigid miniature, in variants, with accessories»**

Год выпуска или пересмотра инструкции: 2024

Рис. 42. Инструкция по применению

10040.AA

STORZ
KARL STORZ – ENDOVISION

Бронхоскоп жесткий миниатюрный, в вариантах исполнения, с принадлежностями: бронхоскоп жесткий миниатюрный, направление наблюдения 0°, диаметр 1,3 мм, длина 18,8 см

РУ № _____ от _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 73532
Tutlingen, Germany (Германия)

Уполномоченный
представитель на
территории РФ Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 43. Макет русскоязычной маркировки




Рис. 44. Пример стикера с символом «Дата изготовления», которым дополняется маркировка изделия

Грошито и стрелено
на 45 място

