


с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист а
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю
"14" 2021 г.

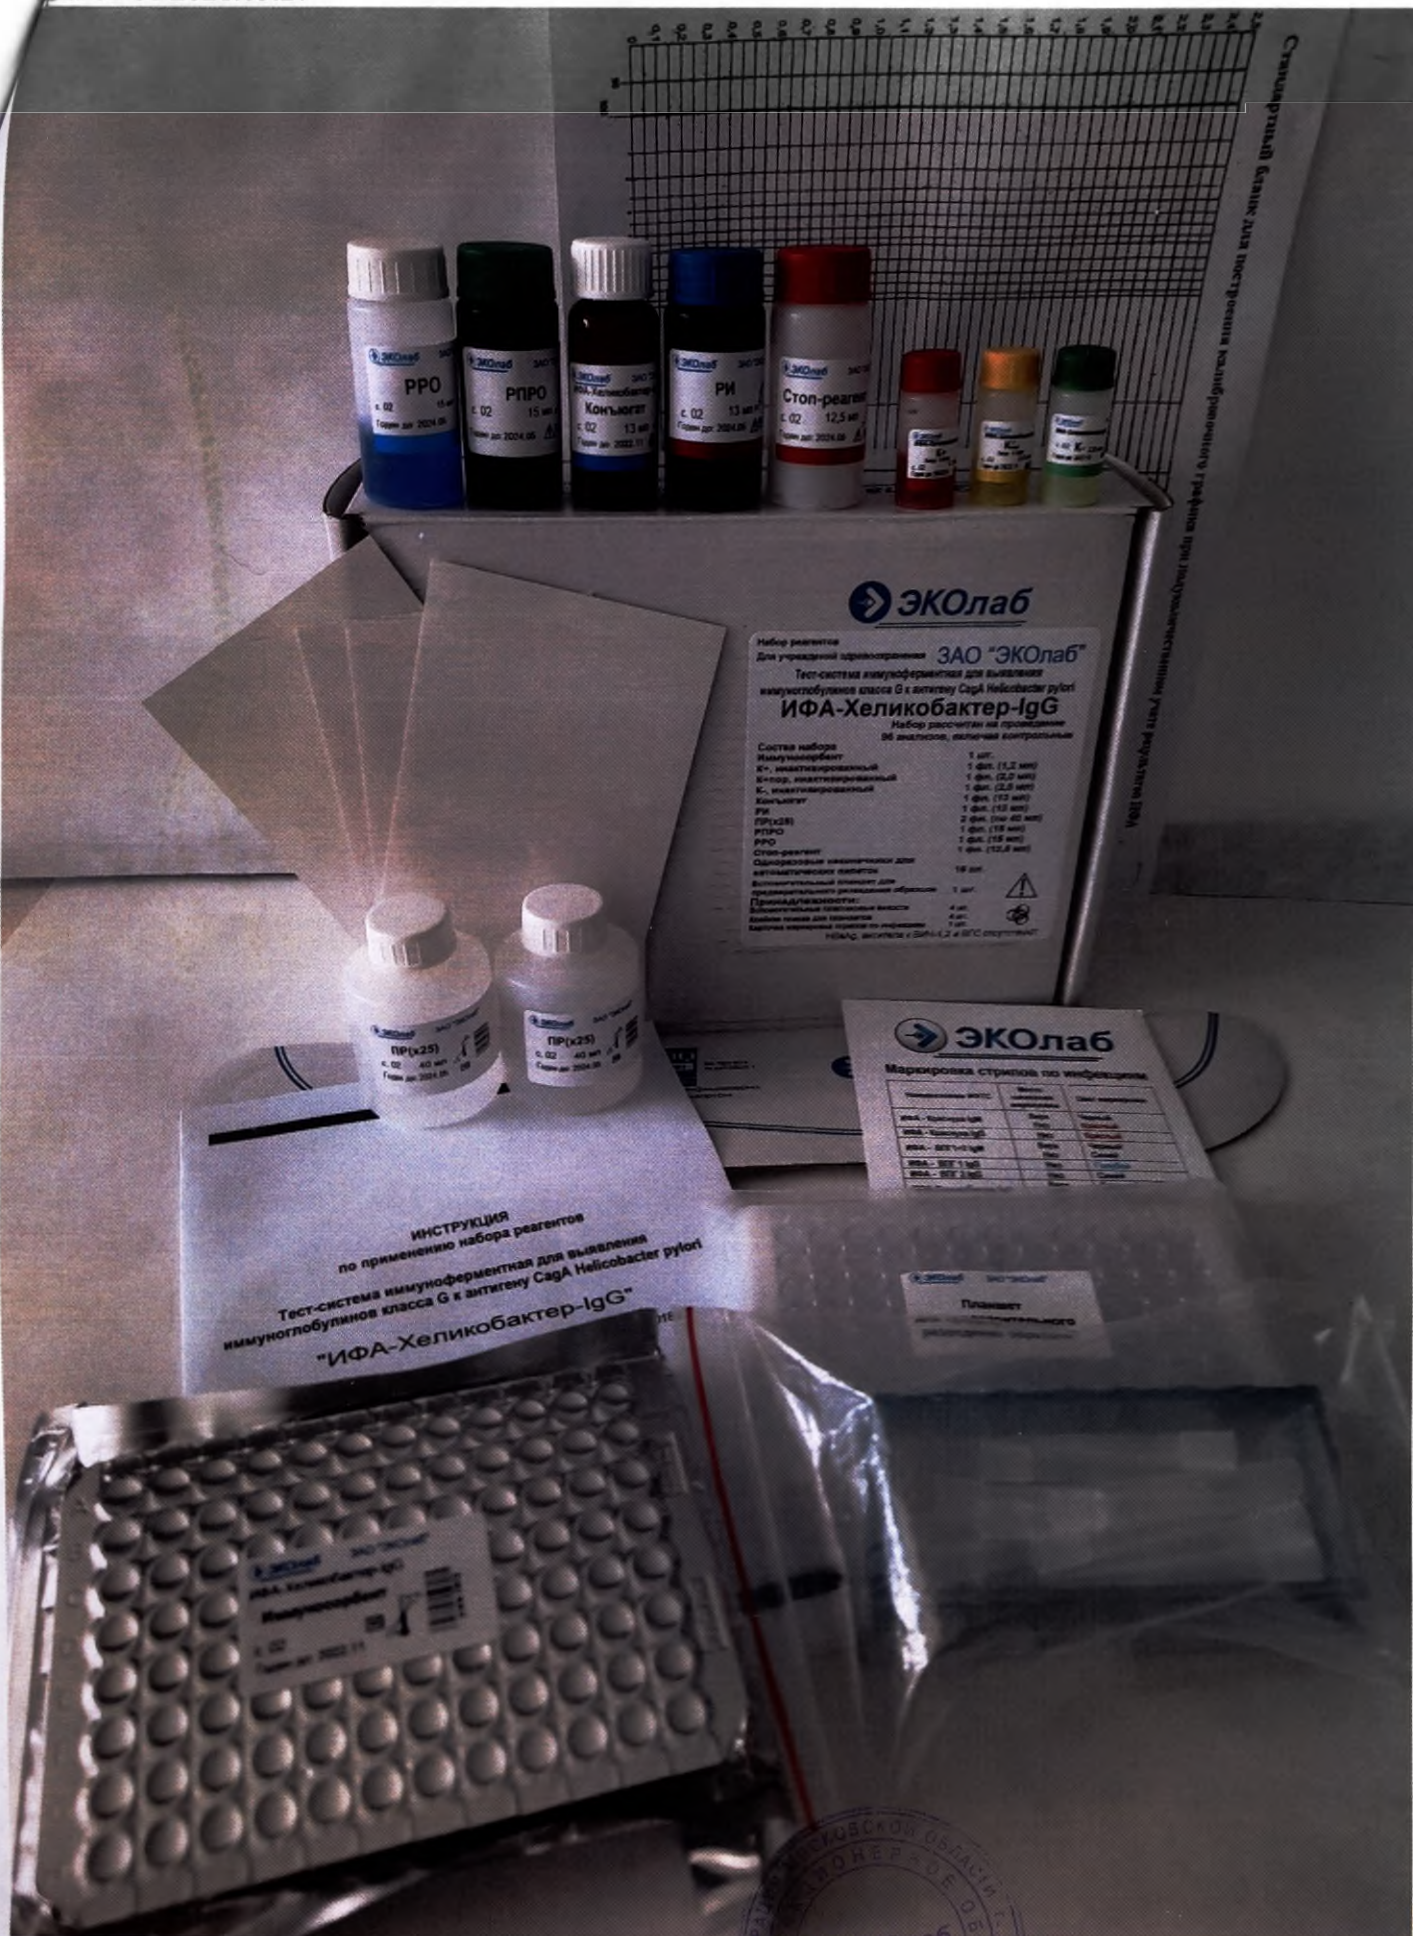

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигену CagA *Helicobacter pylori*

ИФА-Хеликобактер-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

1 шт.

K+, инактивированный

1 фл. (1,2 мл)

K+пор, инактивированный

1 фл. (2,0 мл)

K-, инактивированный

1 фл. (2,0 мл)

Конъюгат

1 фл. (13 мл)

РИ

1 фл. (13 мл)

ПР(x25)

2 фл. (по 40 мл)

РПРО

1 фл. (15 мл)

РРО

1 фл. (15 мл)

Стоп-реагент

1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

16 шт.

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

1 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

4 шт.

Клейкая пленка для планшетов

4 шт.

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

1 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения **ЗАО «ЭКОлаб»**

ИФА-Хеликобактер-IgG

ТУ 9398-087-70423725-2021


РУ №ФСР 2010/08510 от 10.05.2018

Серия 01 Каталогный № 09.02





Контрольный № 272

Дата изготовления: 2021.05.26

Годен до: 2022.11.26



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигену CagA Helicobacter pylori

ИФА-Хеликобактер-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

K+, инактивированный

K+пор, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ПР(x25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

1 шт.

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Хеликобактер-IgG


ТУ 9398-087-70423725-2021

РУ №ФСР 2010/08510 от 10.05.2018

Серия 02 Каталожный № 09.02
Контрольный № 273

Дата изготовления: 2021.05.27

Годеи до: 2022.11.27



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Хеликобактер-IgG

Иммуносорбент

с. 02

Годеи до: 2022.11

ЗАО "ЭКОлаб"

РРО

с. 02

15 мл

Годеи до: 2024.05

ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 02

13 мл

Годеи до: 2024.05

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Хеликобактер-IgG

с. 02 K-

Годеи до: 2022.11

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Хеликобактер-IgG

Конъюгат

с. 02

13 мл

Годеи до: 2022.11

ЗАО "ЭКОлаб"

РПРО

с. 02

15 мл

Годеи до: 2024.05

ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 02

12,5 мл

Годеи до: 2024.05

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Хеликобактер-IgG

с. 02 K+

Годеи до: 2022.11

ЗАО "ЭКОлаб"

ПР(x25)

с. 02

40 мл

Годеи до: 2024.05

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю

2021 г.

