



Внешний вид медицинского изделия
«Набор реагентов для выявления антител к кардиолипину антигену в реакции флоккуляции (Сифилис RPR-тест)»
Комплект № 1
Серия 01 от 2019.04

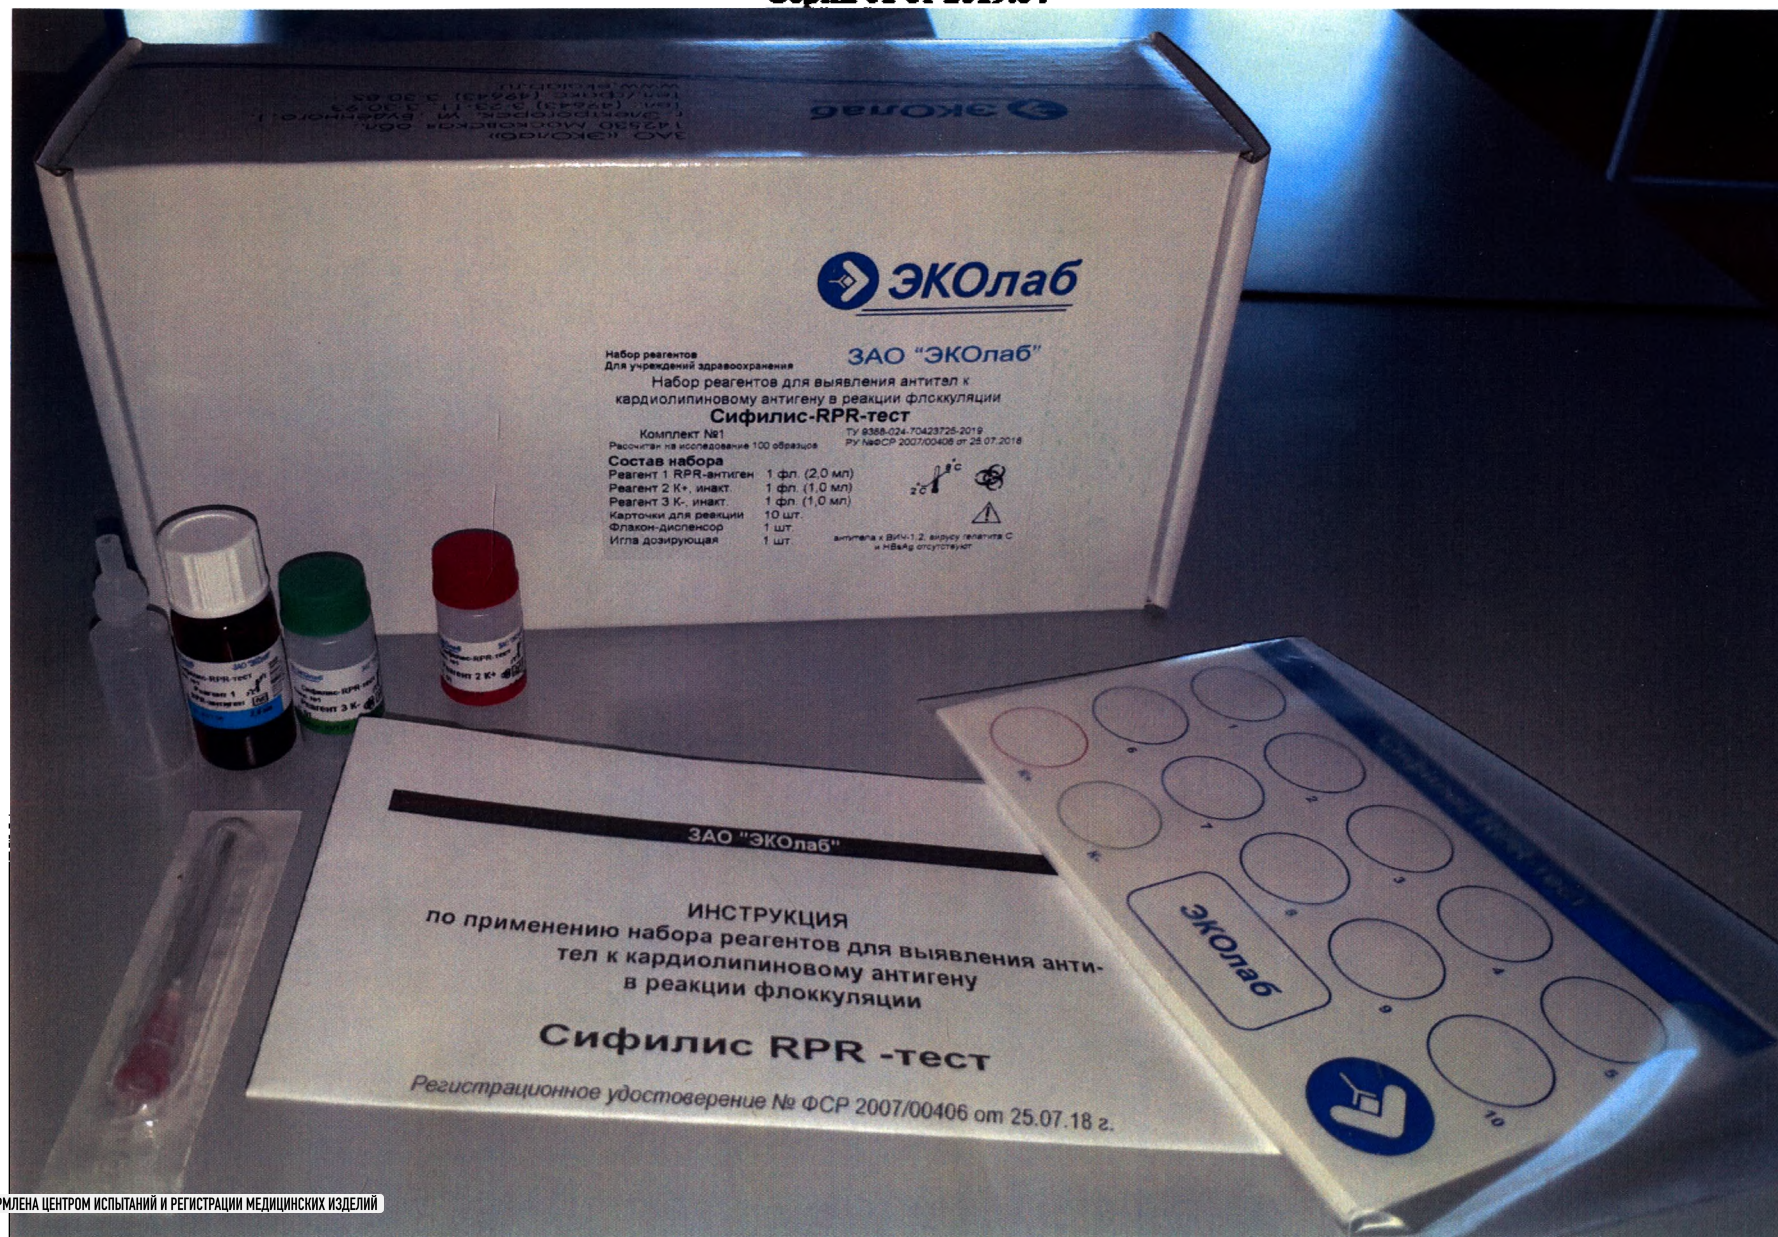


Серия 02 от 2019.04

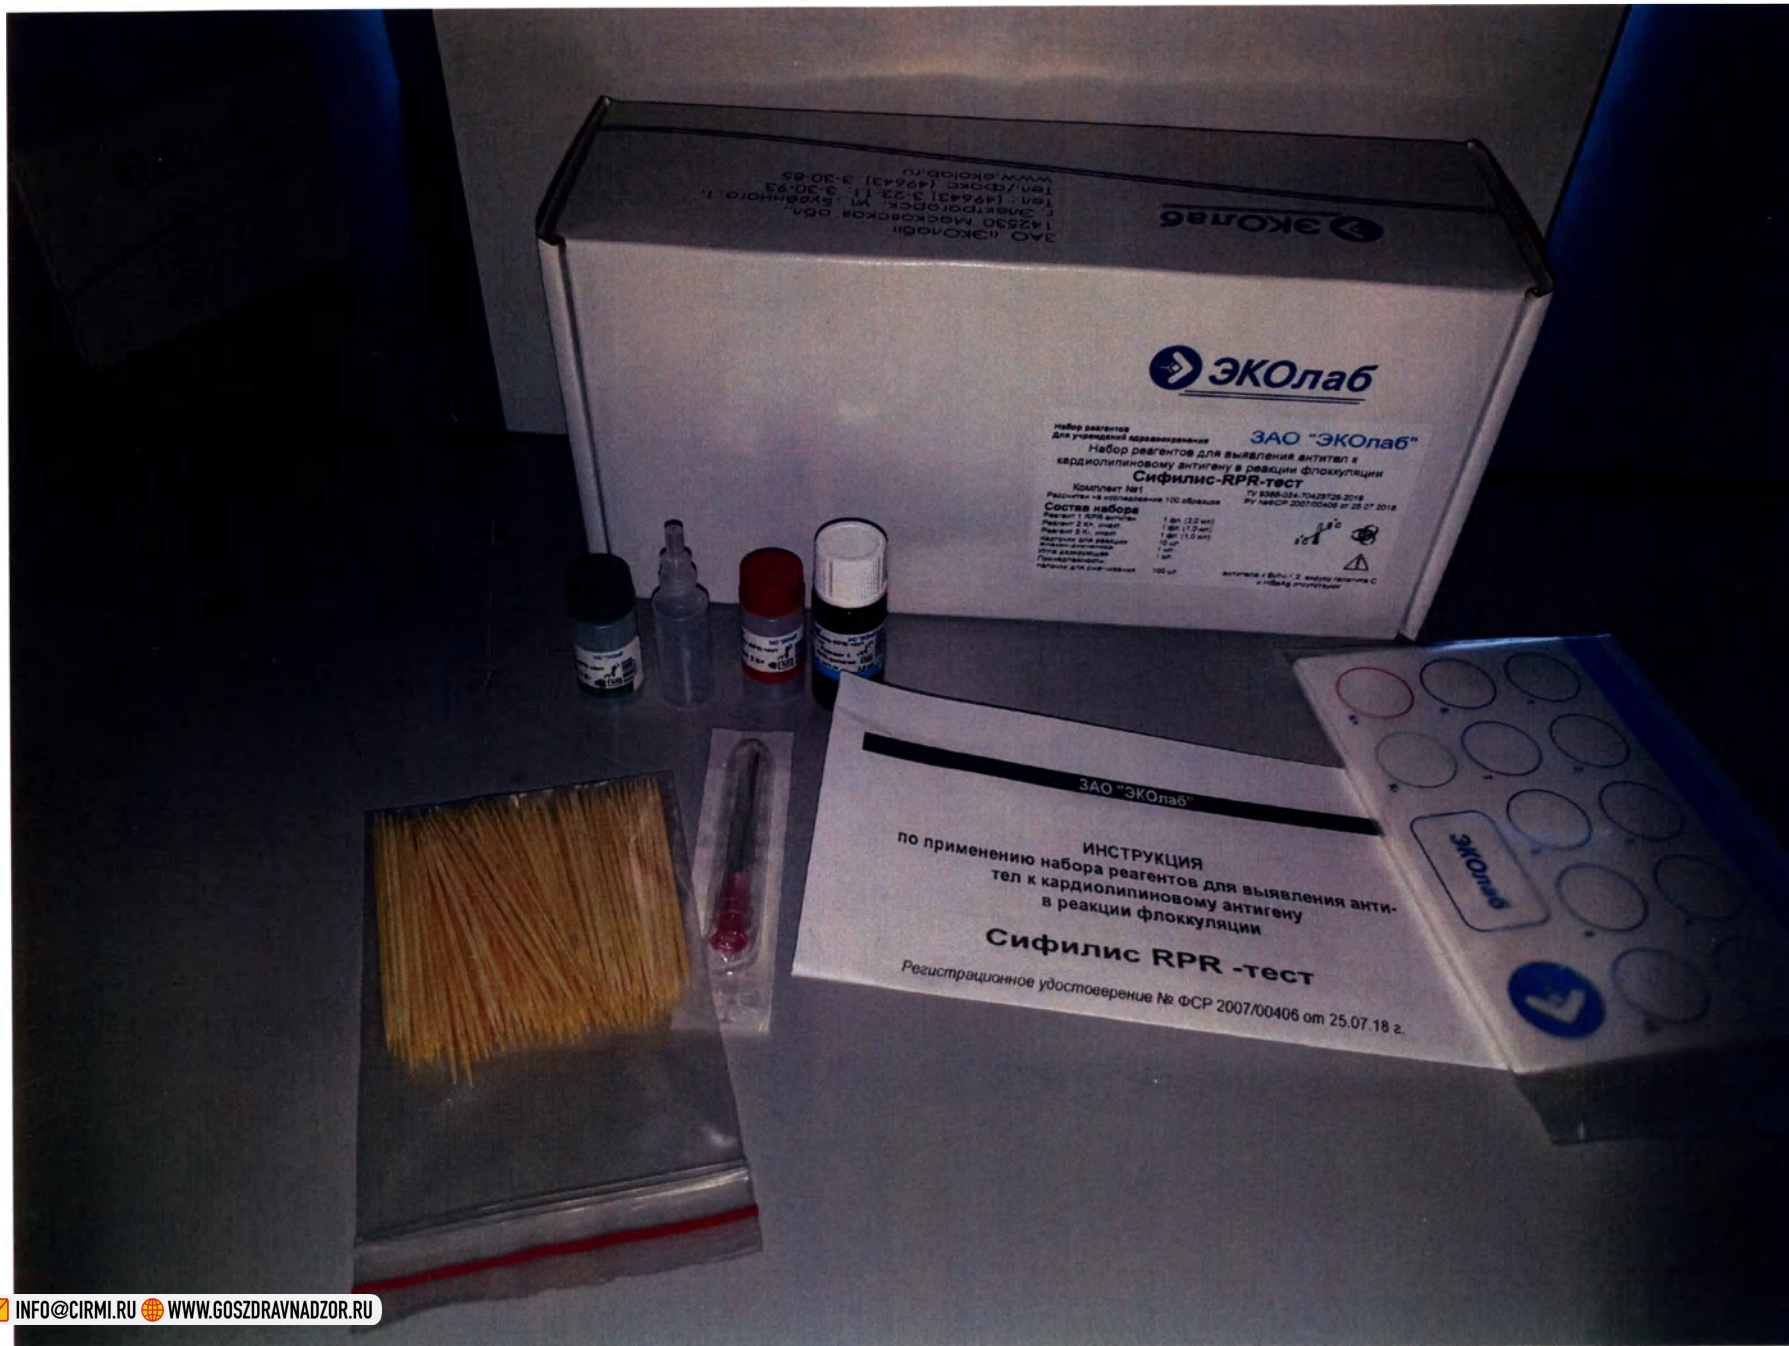


Комплект № 2
Серия 03 от 2019.04




Серия 04 от 2019.04

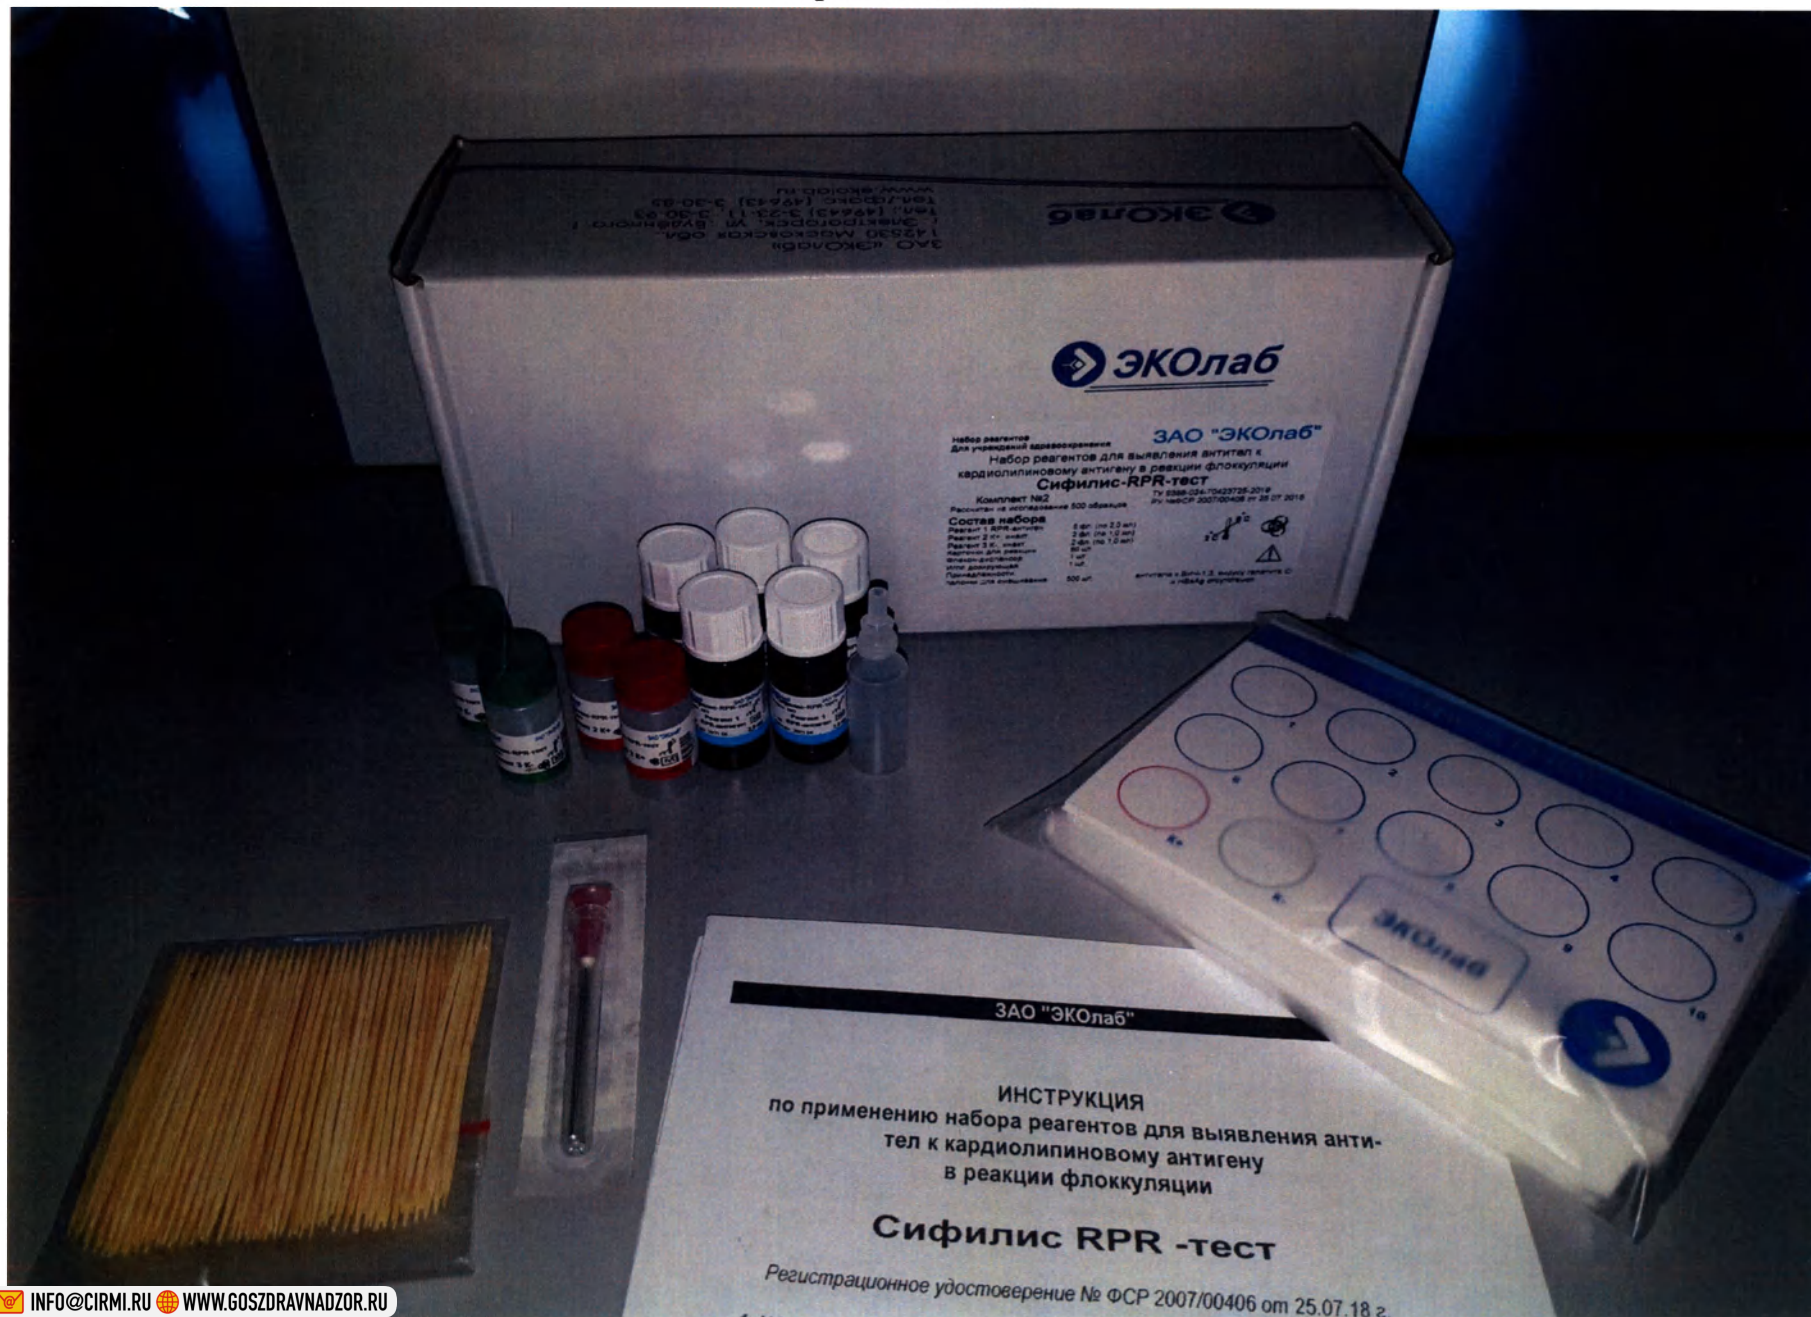

КОМПЛЕКТ № 3
Серия 05 от 2019.04

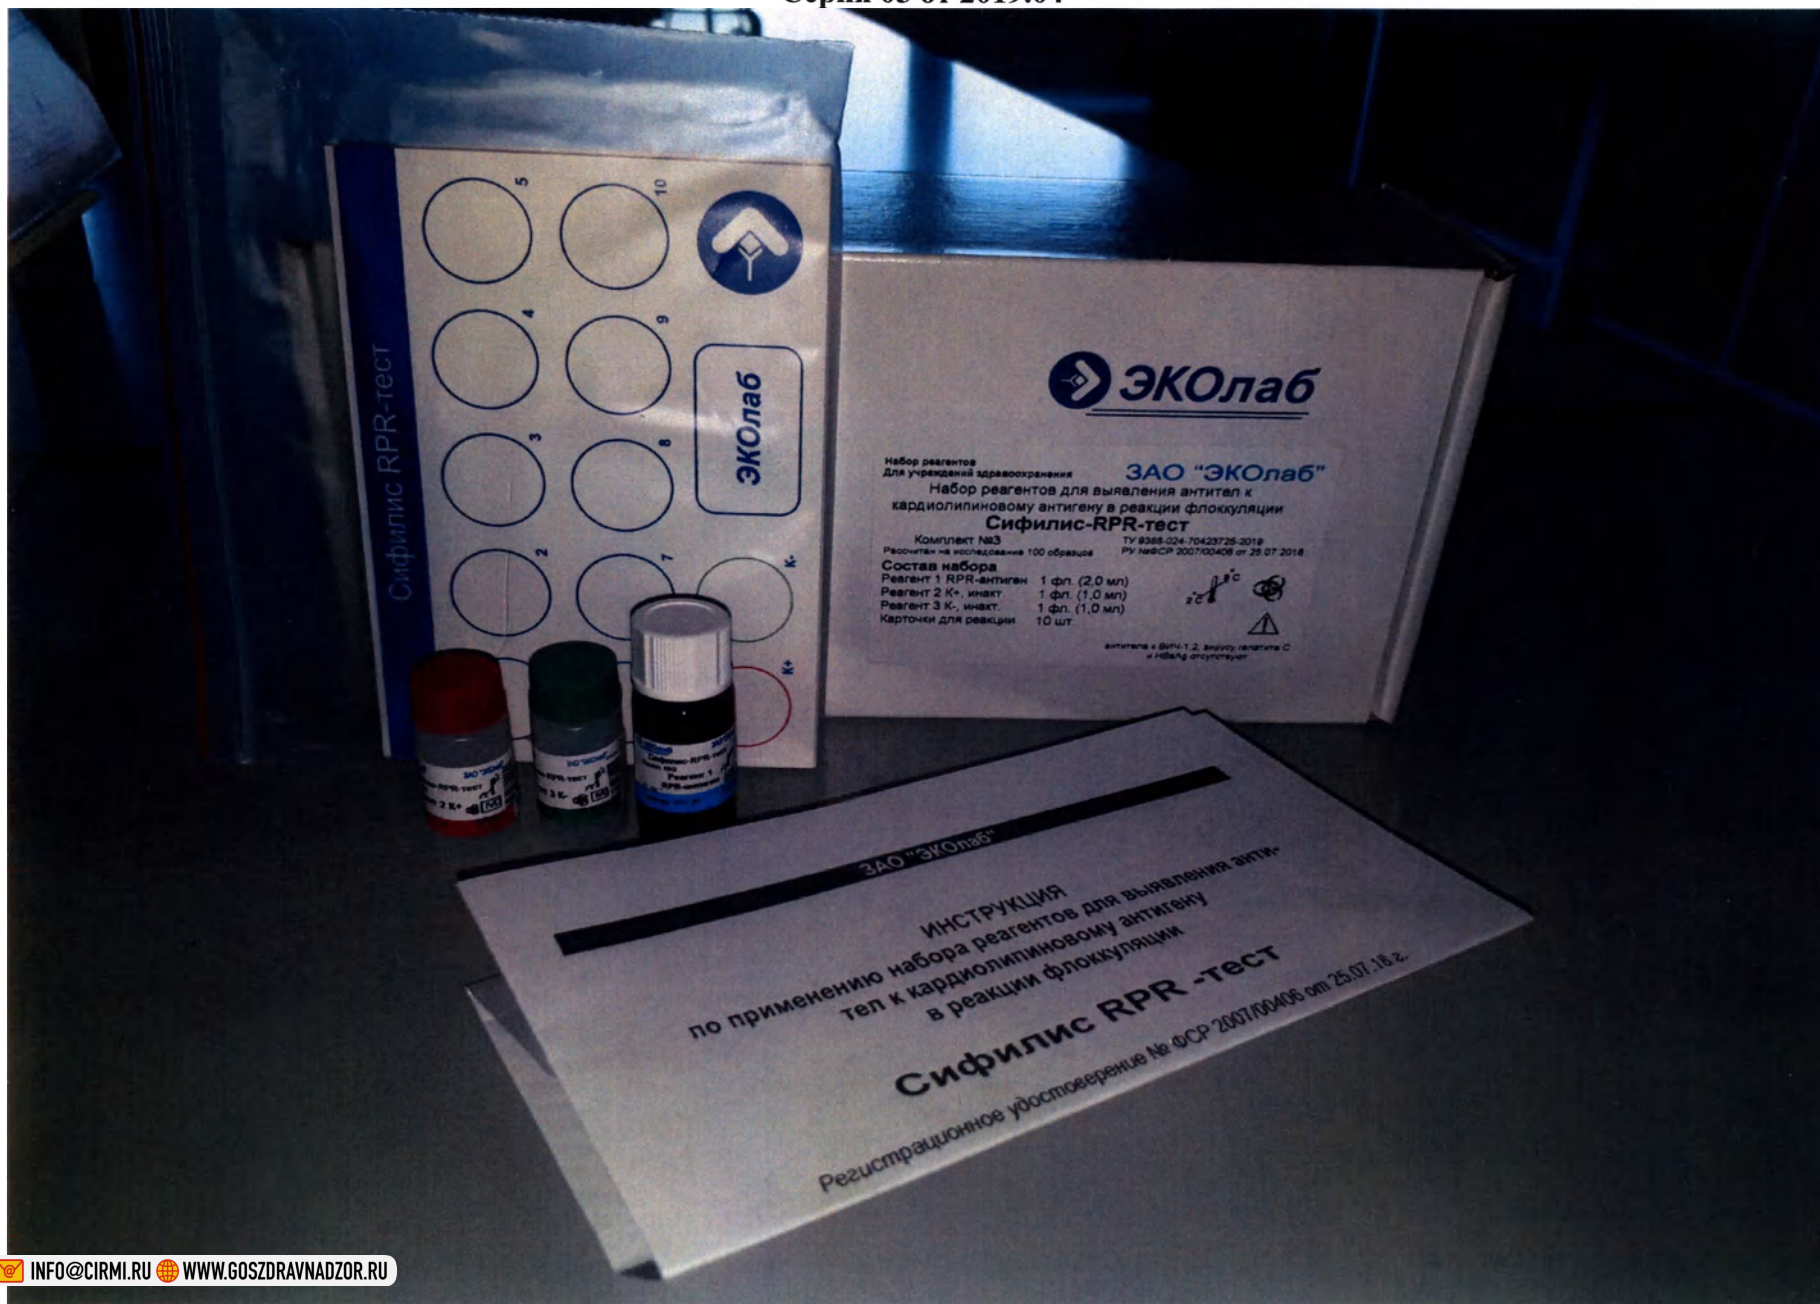


Серия 06 от 2019.04

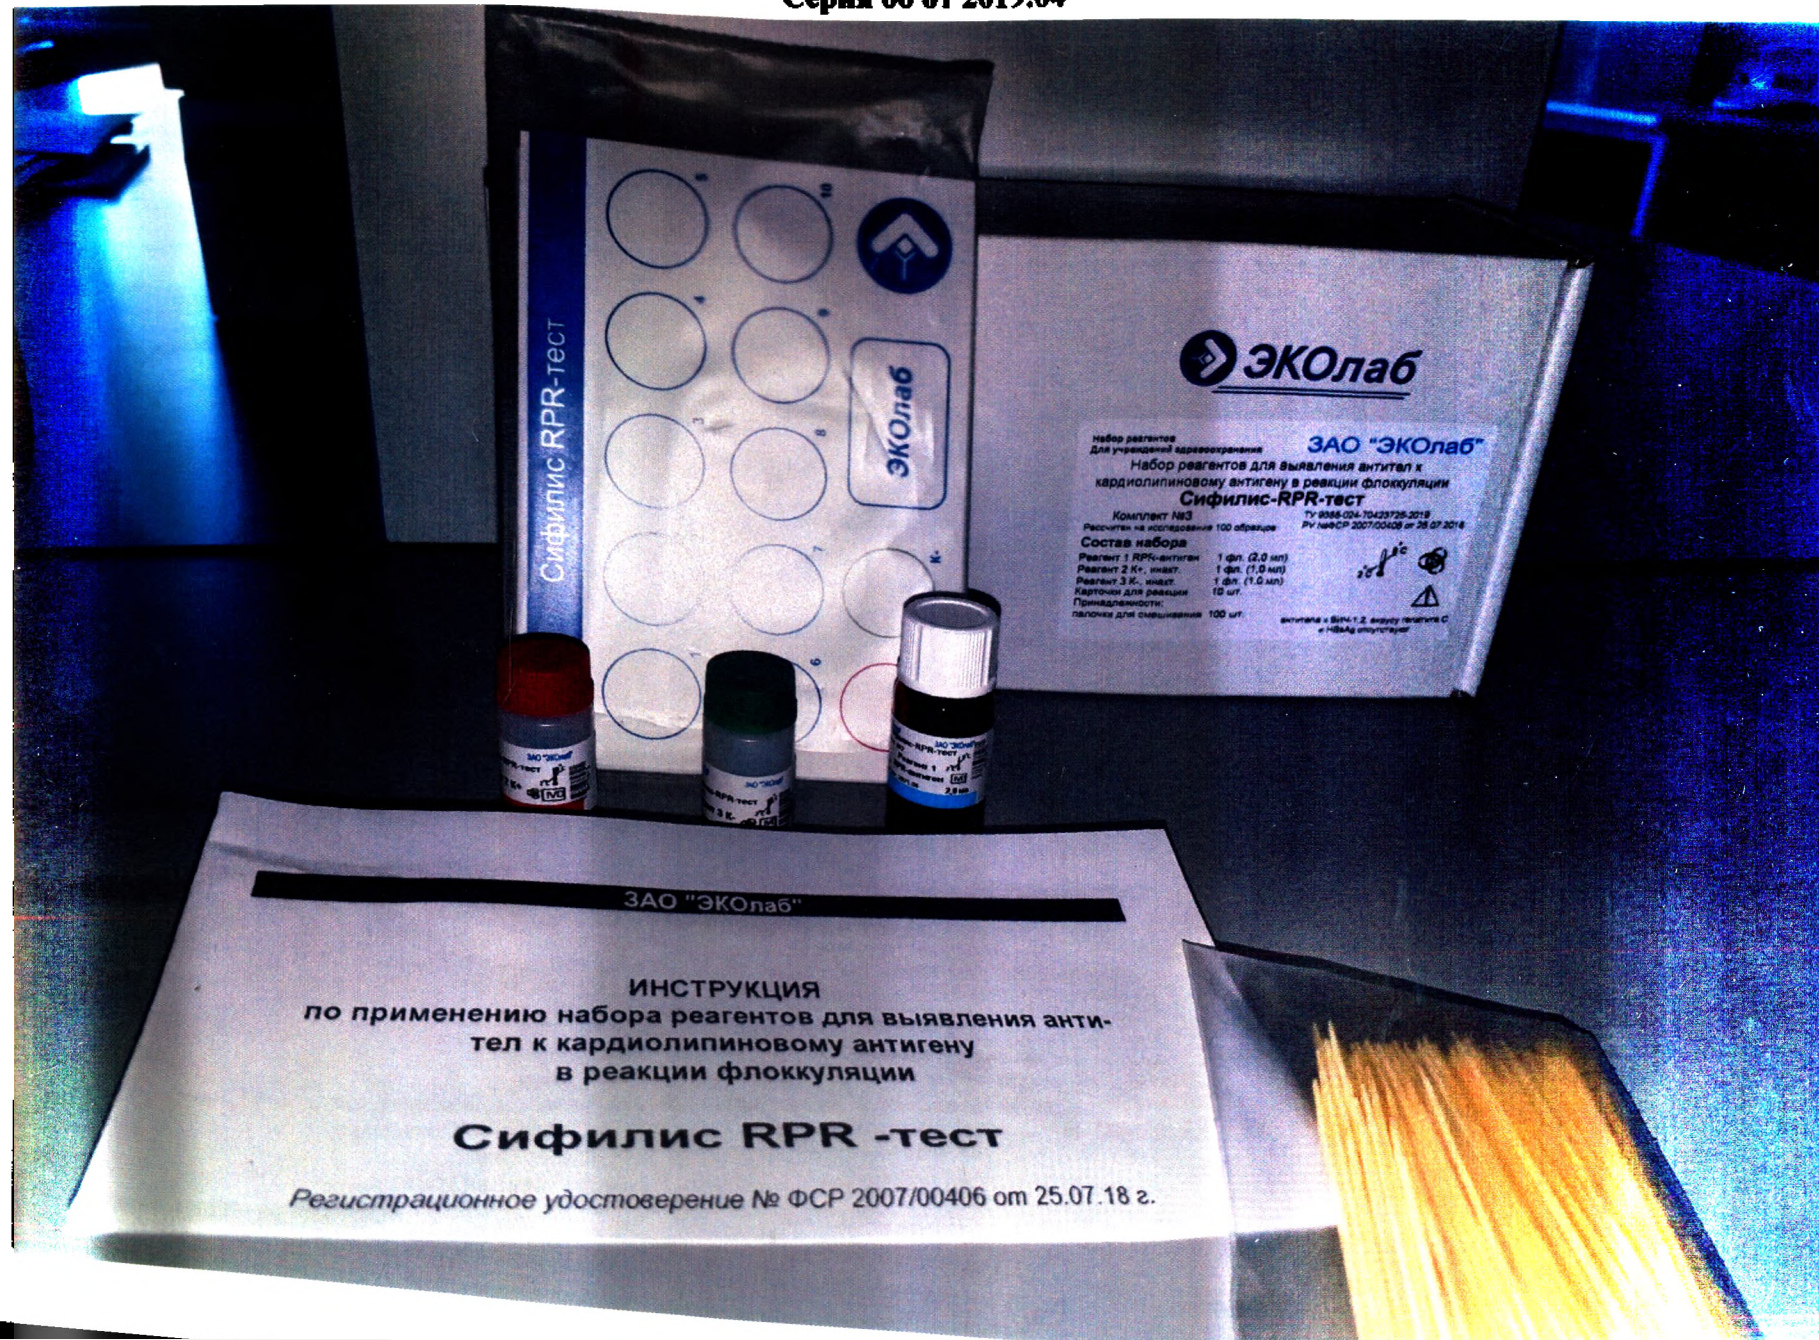

Комплект № 4
Серия 07 от 2019.04



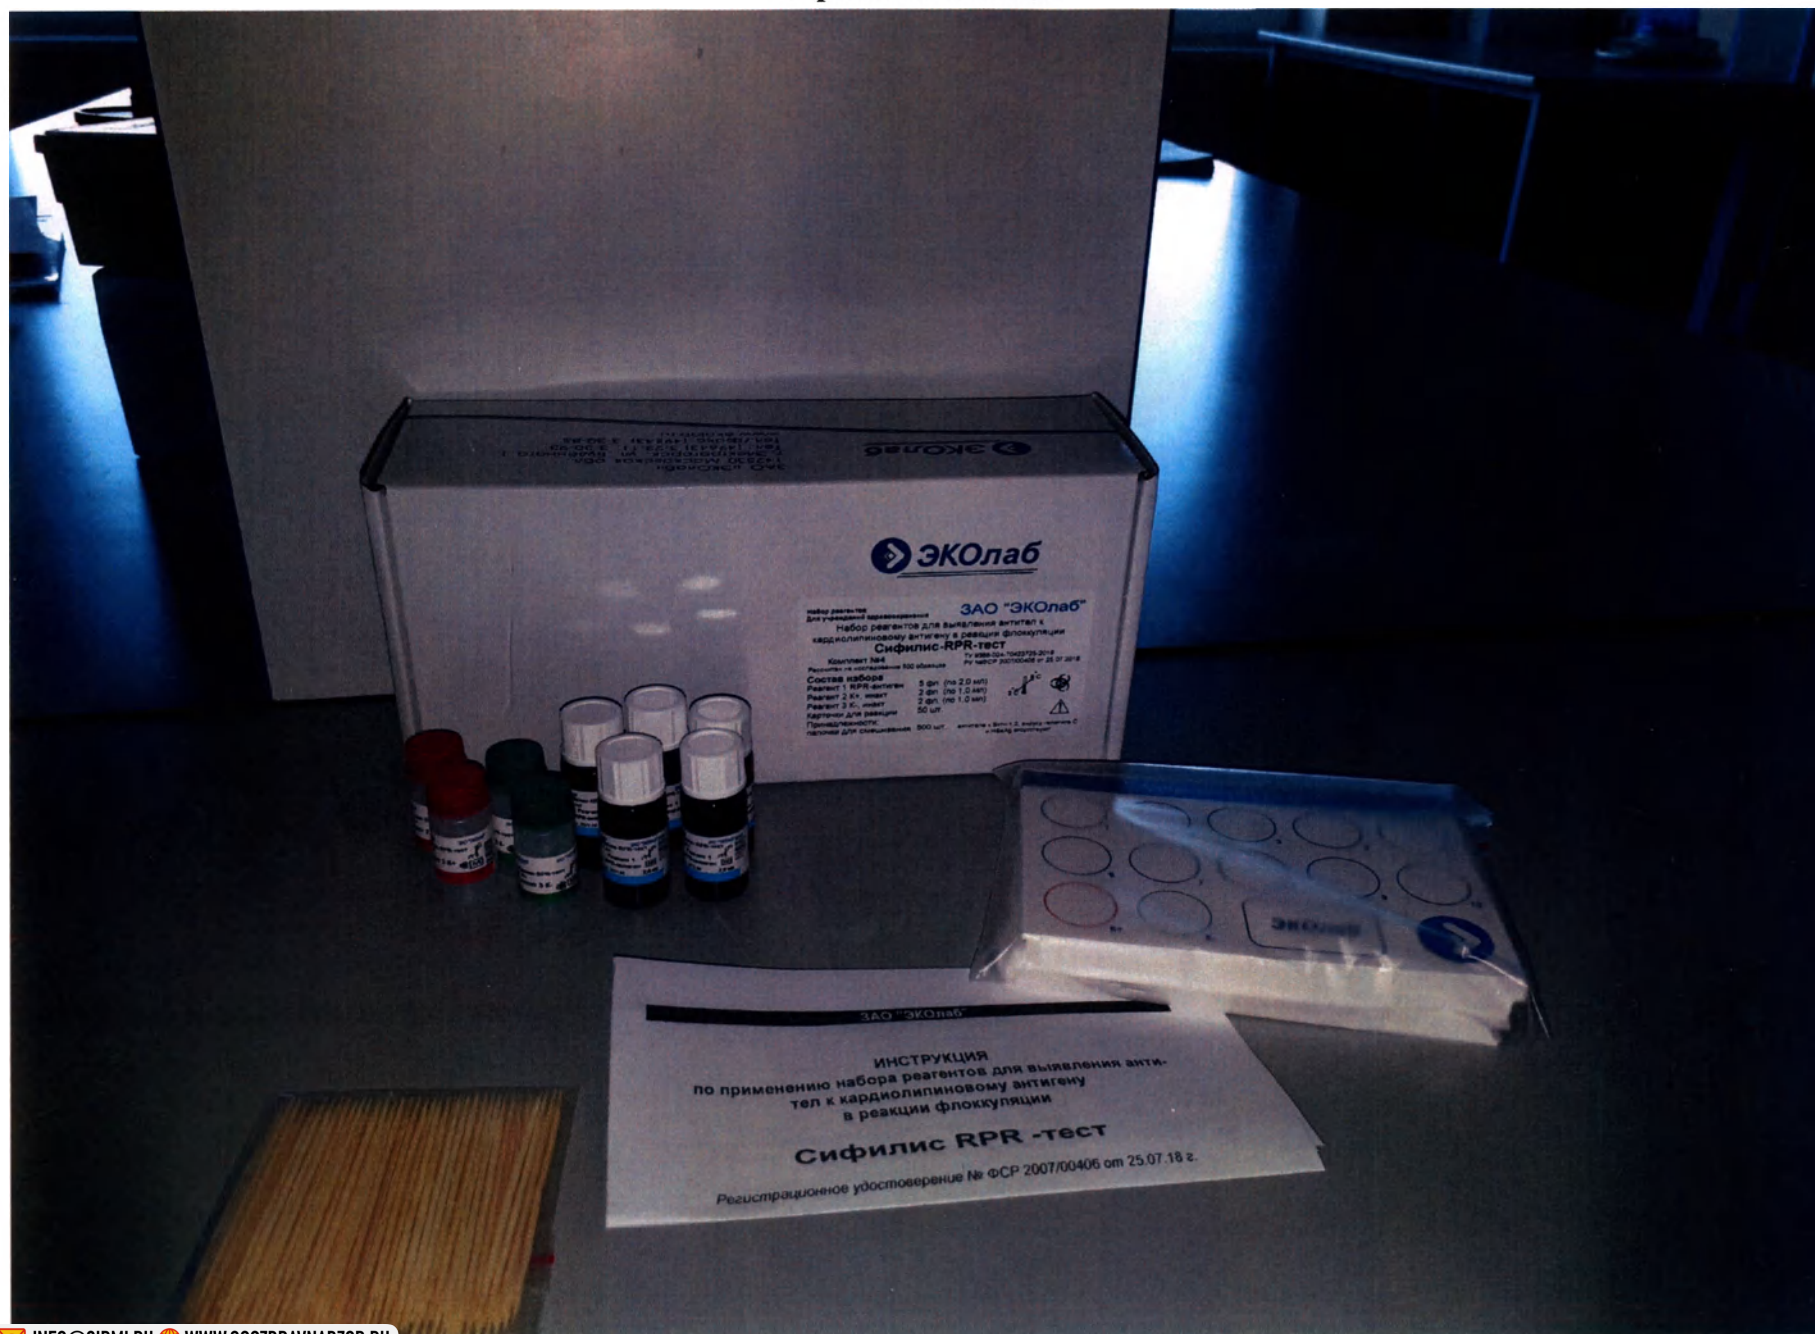

Образец упаковки



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 96

Ген. Директор ЗАО "ЭКОЛаб"
Бориса В.Ю.

"24" 04 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

"05" 04 20 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипину в реакции флоккуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №1

ТУ 8388-024-70423725-2019

Расчитан на исследование 100 образцов

РУ №ФСР 2007/00408 от 25.07.2018

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген	1 фл. (2,0 мл)
Реагент 2 K+, инакт.	1 фл. (1,0 мл)
Реагент 3 K-, инакт.	1 фл. (1,0 мл)
Карточки для реакции	10 шт.
Флакон-диспенсор	1 шт.
Игла дозирующая	1 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют



ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 1

Каталожный №: 03.13

Серия: 01



Контрольный №: **

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
" 05 " 20 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

реактивов
здравоохранения

Набор реагентов для выявления антител к
радиолипинному антигену в реакции флоккуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №1
антител на исследование 100 образцов
ТУ 9388-024-70423725-2019
РУ НаФСР 2007/00406 от 25.07.2018

Состав набора

1 RPR-антиген	1 фл. (2,0 мл)
2 К+, инакт.	1 фл. (1,0 мл)
3 К-, инакт.	1 фл. (1,0 мл)
для реакции	10 шт.
диспенсор	1 шт.
взвешивающая	1 шт.
для смешивания	100 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют




ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 1
Каталожный №: 03.13
Серия: 02
Контрольный №: **
Дата изготовления: 2019.04
Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

"06" 09 20 г.



ЗАО "ЭКОлаб"

для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипиновому антигену в реакции флоркуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №2


ТУ 8388-024-70423725-2019

рассчитан на исследование 500 образцов

ПУ №ФСР 2007/00408 от 25.07.2018

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген	5 фл. (по 2,0 мл)
Реагент 2 K+, инакт.	2 фл. (по 1,0 мл)
Реагент 3 K-, инакт.	2 фл. (по 1,0 мл)
Полочки для реакции	50 шт.
Микродиспенсор	1 шт.
Пипетка дозирующая	1 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют



ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 2

Каталожный №: 03.14

Серия: 03




Контрольный №: ""

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 05 " 20 20 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

для реагентов
предприятий здравоохранения

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипидному антигену в реакции флуккуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №2

ТУ 9388-024-70423725-2019

РУ №ФСР 2007/00408 от 25.07.2018

используется на исследование 500 образцов

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген	5 фл. (по 2,0 мл)
Реагент 2 К+, инакт.	2 фл. (по 1,0 мл)
Реагент 3 К-, инакт.	2 фл. (по 1,0 мл)
Почки для реакции	50 шт.
Вспомогательная дозирующая	1 шт.
Надлежащая:	1 шт.
Почки для смешивания	500 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 2

Каталожный №: 03.14

Серия: 04




Контрольный №: **

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 05 " 09 20 г.

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипидному антигену в реакции флоркуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №3


ТУ 9388-024-70423725-2019

Рассчитан на исследование 100 образцов

ПУ №ФСР 2007/00408 от 25.07.2018

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген 1 фл. (2,0 мл)
Реагент 2 К+, инакт. 1 фл. (1,0 мл)
Реагент 3 К-, инакт. 1 фл. (1,0 мл)
Карточки для реакции 10 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 3


Каталожный №: 03.13.1

Серия: 05




Контрольный №: **

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
" 05 " 04 20 г.

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипину в реакции флоккуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №3

ТУ 9388-024-70423725-2019


Рассчитан на исследование 100 образцов

ПУ №ФСР 2007/00408 от 25.07.2018

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген 1 фл. (2,0 мл)
Реагент 2 К+, инакт. 1 фл. (1,0 мл)
Реагент 3 К-, инакт. 1 фл. (1,0 мл)
Карточки для реакции 10 шт.

Принадлежности:
палочки для смешивания 100 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 3

Каталожный №: 03.13.1

Серия: 06




Контрольный №: **

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

"06" 20 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №4


ТУ 9388-024-70423725-2019

Рассчитан на исследование 500 образцов

ПУ №ФСР 2007/00408 от 25.07.2018

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген	5 фл. (по 2,0 мл)
Реагент 2 K+, инакт.	2 фл. (по 1,0 мл)
Реагент 3 K-, инакт.	2 фл. (по 1,0 мл)
Карточки для реакции	50 шт.



антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 4

Каталожный №: 03.14.1

Серия: 07




Контрольный №: **

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

"06" 20 г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для выявления антител к
кардиолипину в реакции флоркуляции

Сифилис-RPR-тест

Комплект №4

ТУ 9388-024-70423725-2019

Рассчитан на исследование 500 образцов

ПУ №ФСР 2007/00406 от 25.07.2018

Состав набора

Реагент 1 RPR-антиген 5 фл. (по 2,0 мл)

Реагент 2 К+, инакт. 2 фл. (по 1,0 мл)


Реагент 3 К-, инакт. 2 фл. (по 1,0 мл)

Карточки для реакции 50 шт.

Принадлежности:

палочки для смешивания 500 шт.

антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис RPR-тест Комплект №: 4

Каталожный №: 03.14.1

Серия: 08



Контрольный №: **

Дата изготовления: 2019.04

Годен до: 2021.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 06
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"24" 04 2019 г.