


**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения Д-димера в образцах сыворотки,
плазмы или цельной крови человека» «ИХА-Д-димер».**

Комплект №1

Серия 01 от 2018.11.

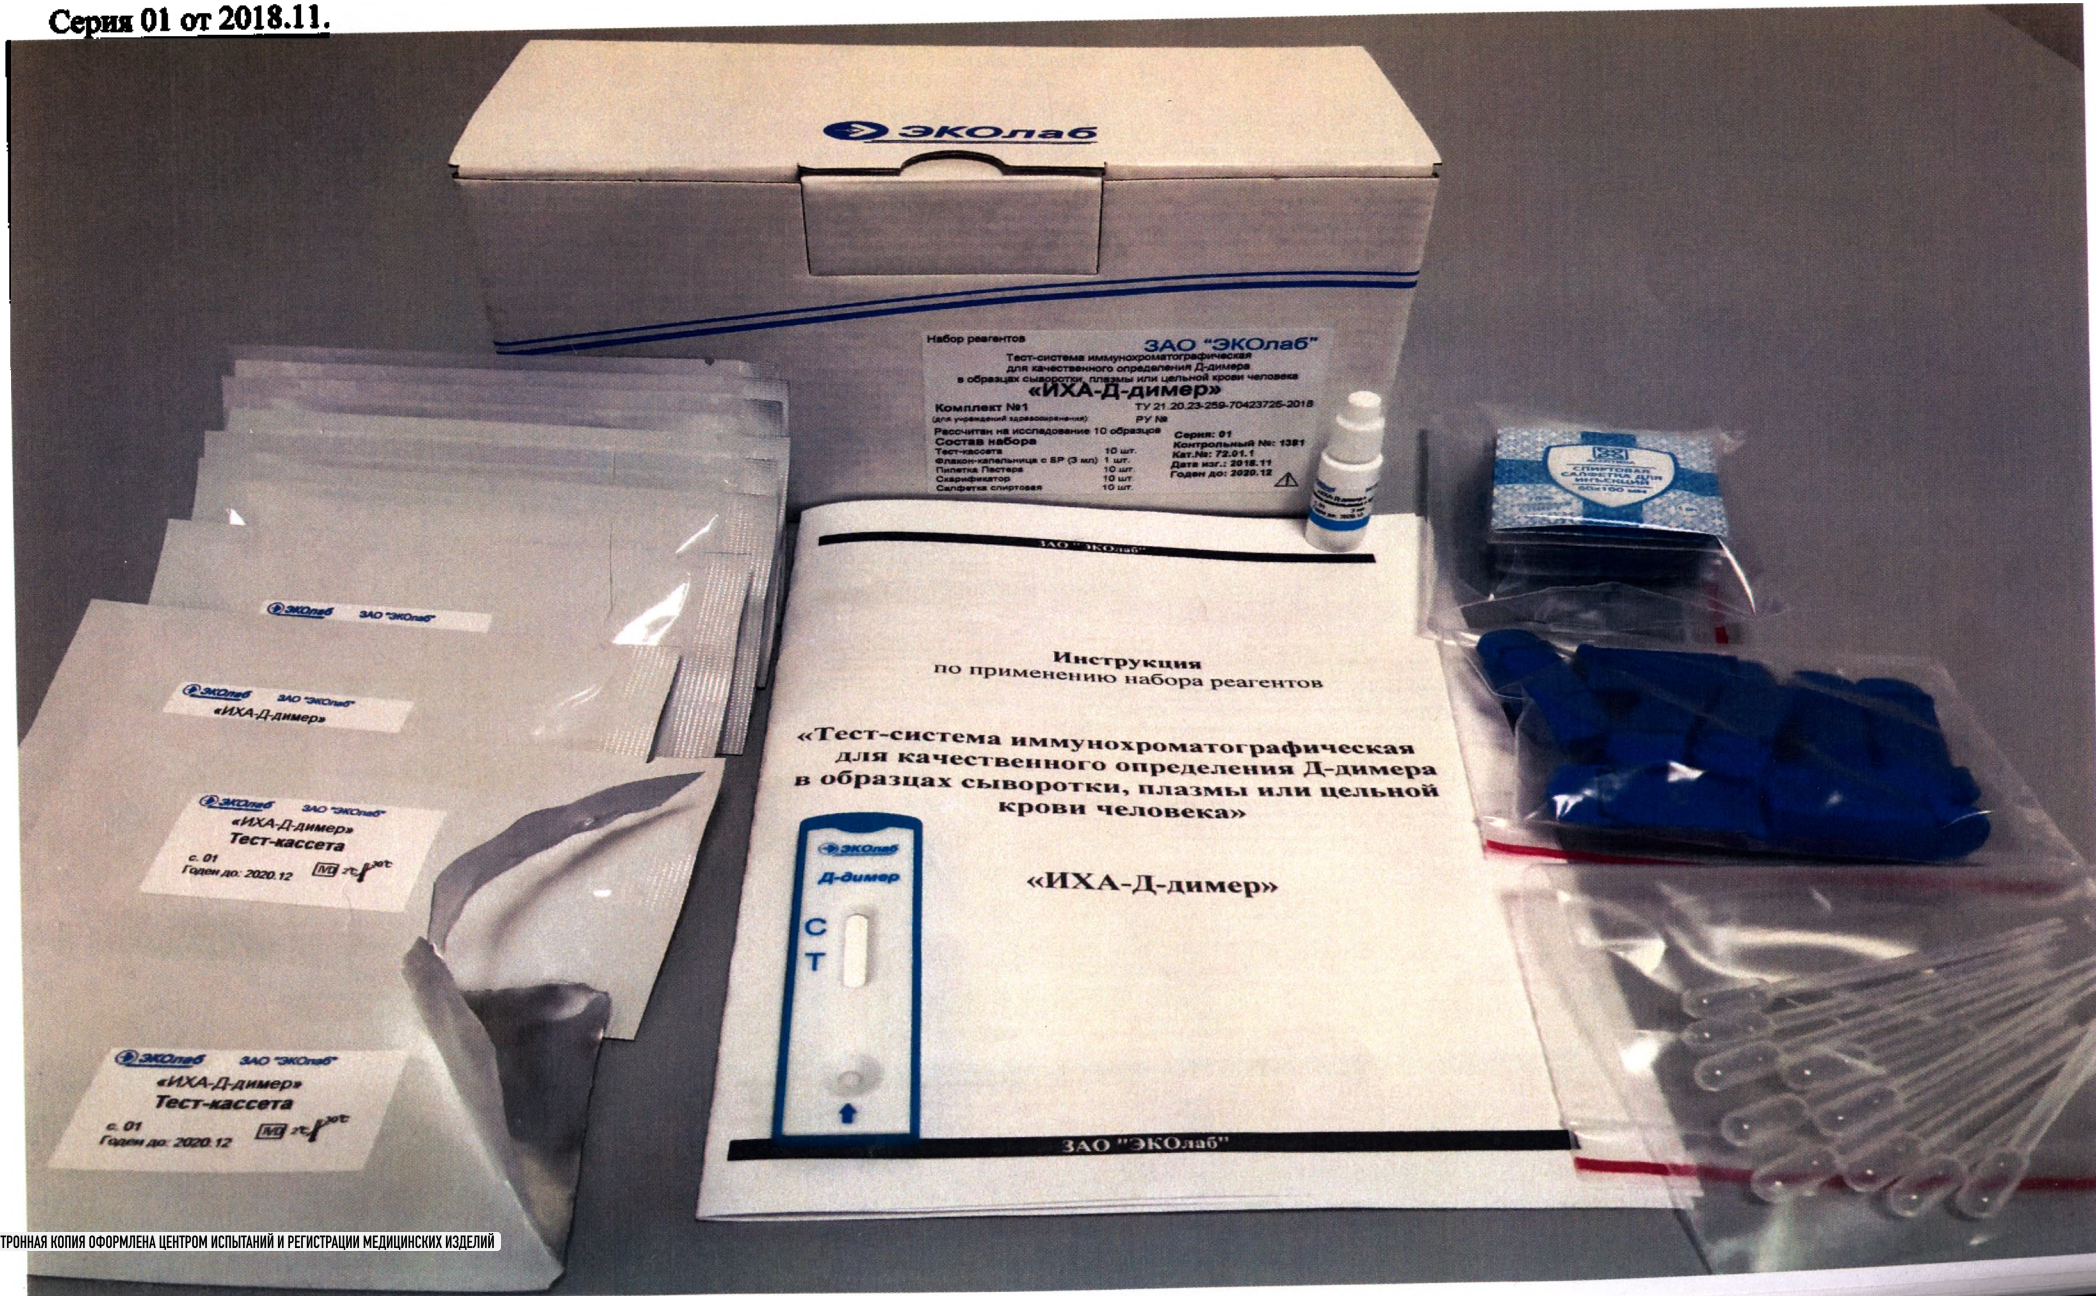

ЭКОлаб

Набор реагентов
ЗАО "ЭКОлаб"
Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения Д-димера
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«ИХА-Д-димер»
Комплект №1
(для учреждений здравоохранения)
Рассчитан на исследование 10 образцов
Состав набора
Тест-кассета 10 шт.
Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
Пипетка Тестера 10 шт.
Стерилизатор 10 шт.
Смешиватель 10 шт.
ТУ 21.20.23-255-70423725-2018
Р/У №
Серия: 03
Контрольный №: 1383
Кат. №: 72.01.1
Дата изг.: 2018.11
Годен до: 2020.12

ЗАО "ЭКОлаб"
«ИХА-Д-димер»
Тест-кассета
с. 03
Годен до: 2020.12

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"
«ИХА-Д-димер»
Тест-кассета
с. 03
Годен до: 2020.12

ЗАО "ЭКОлаб"
«ИХА-Д-димер»
Тест-кассета
с. 03
Годен до: 2020.12


Инструкция по применению набора реагентов



«Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения Д-димера
в образцах сыворотки, плазмы или цельной
крови человека»


«ИХА-Д-димер»




ЗАО "ЭКОлаб"

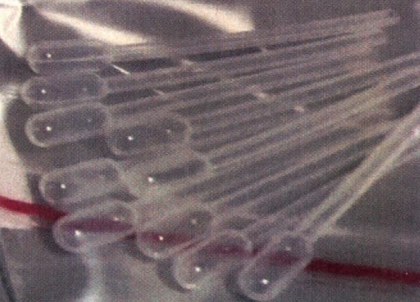

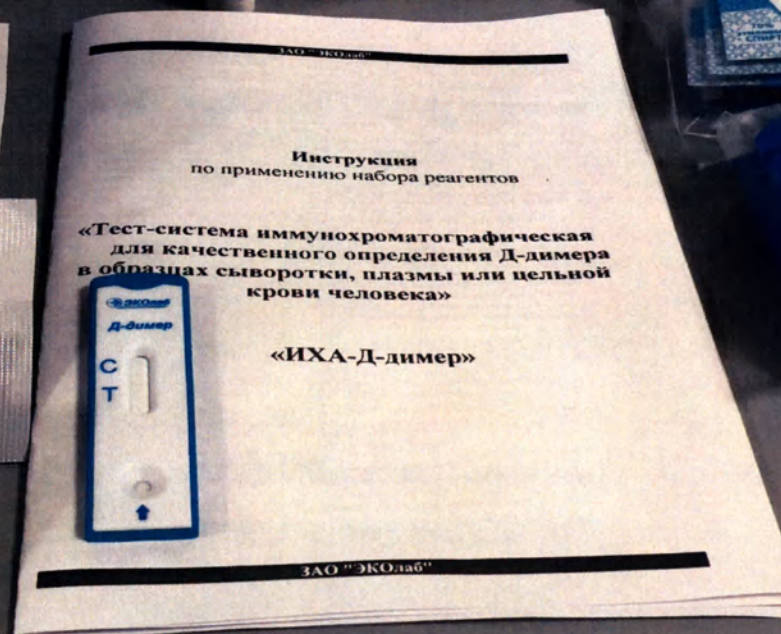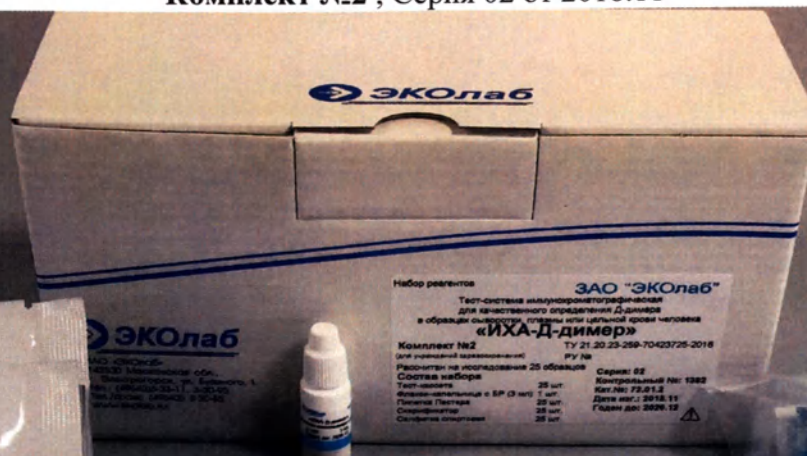

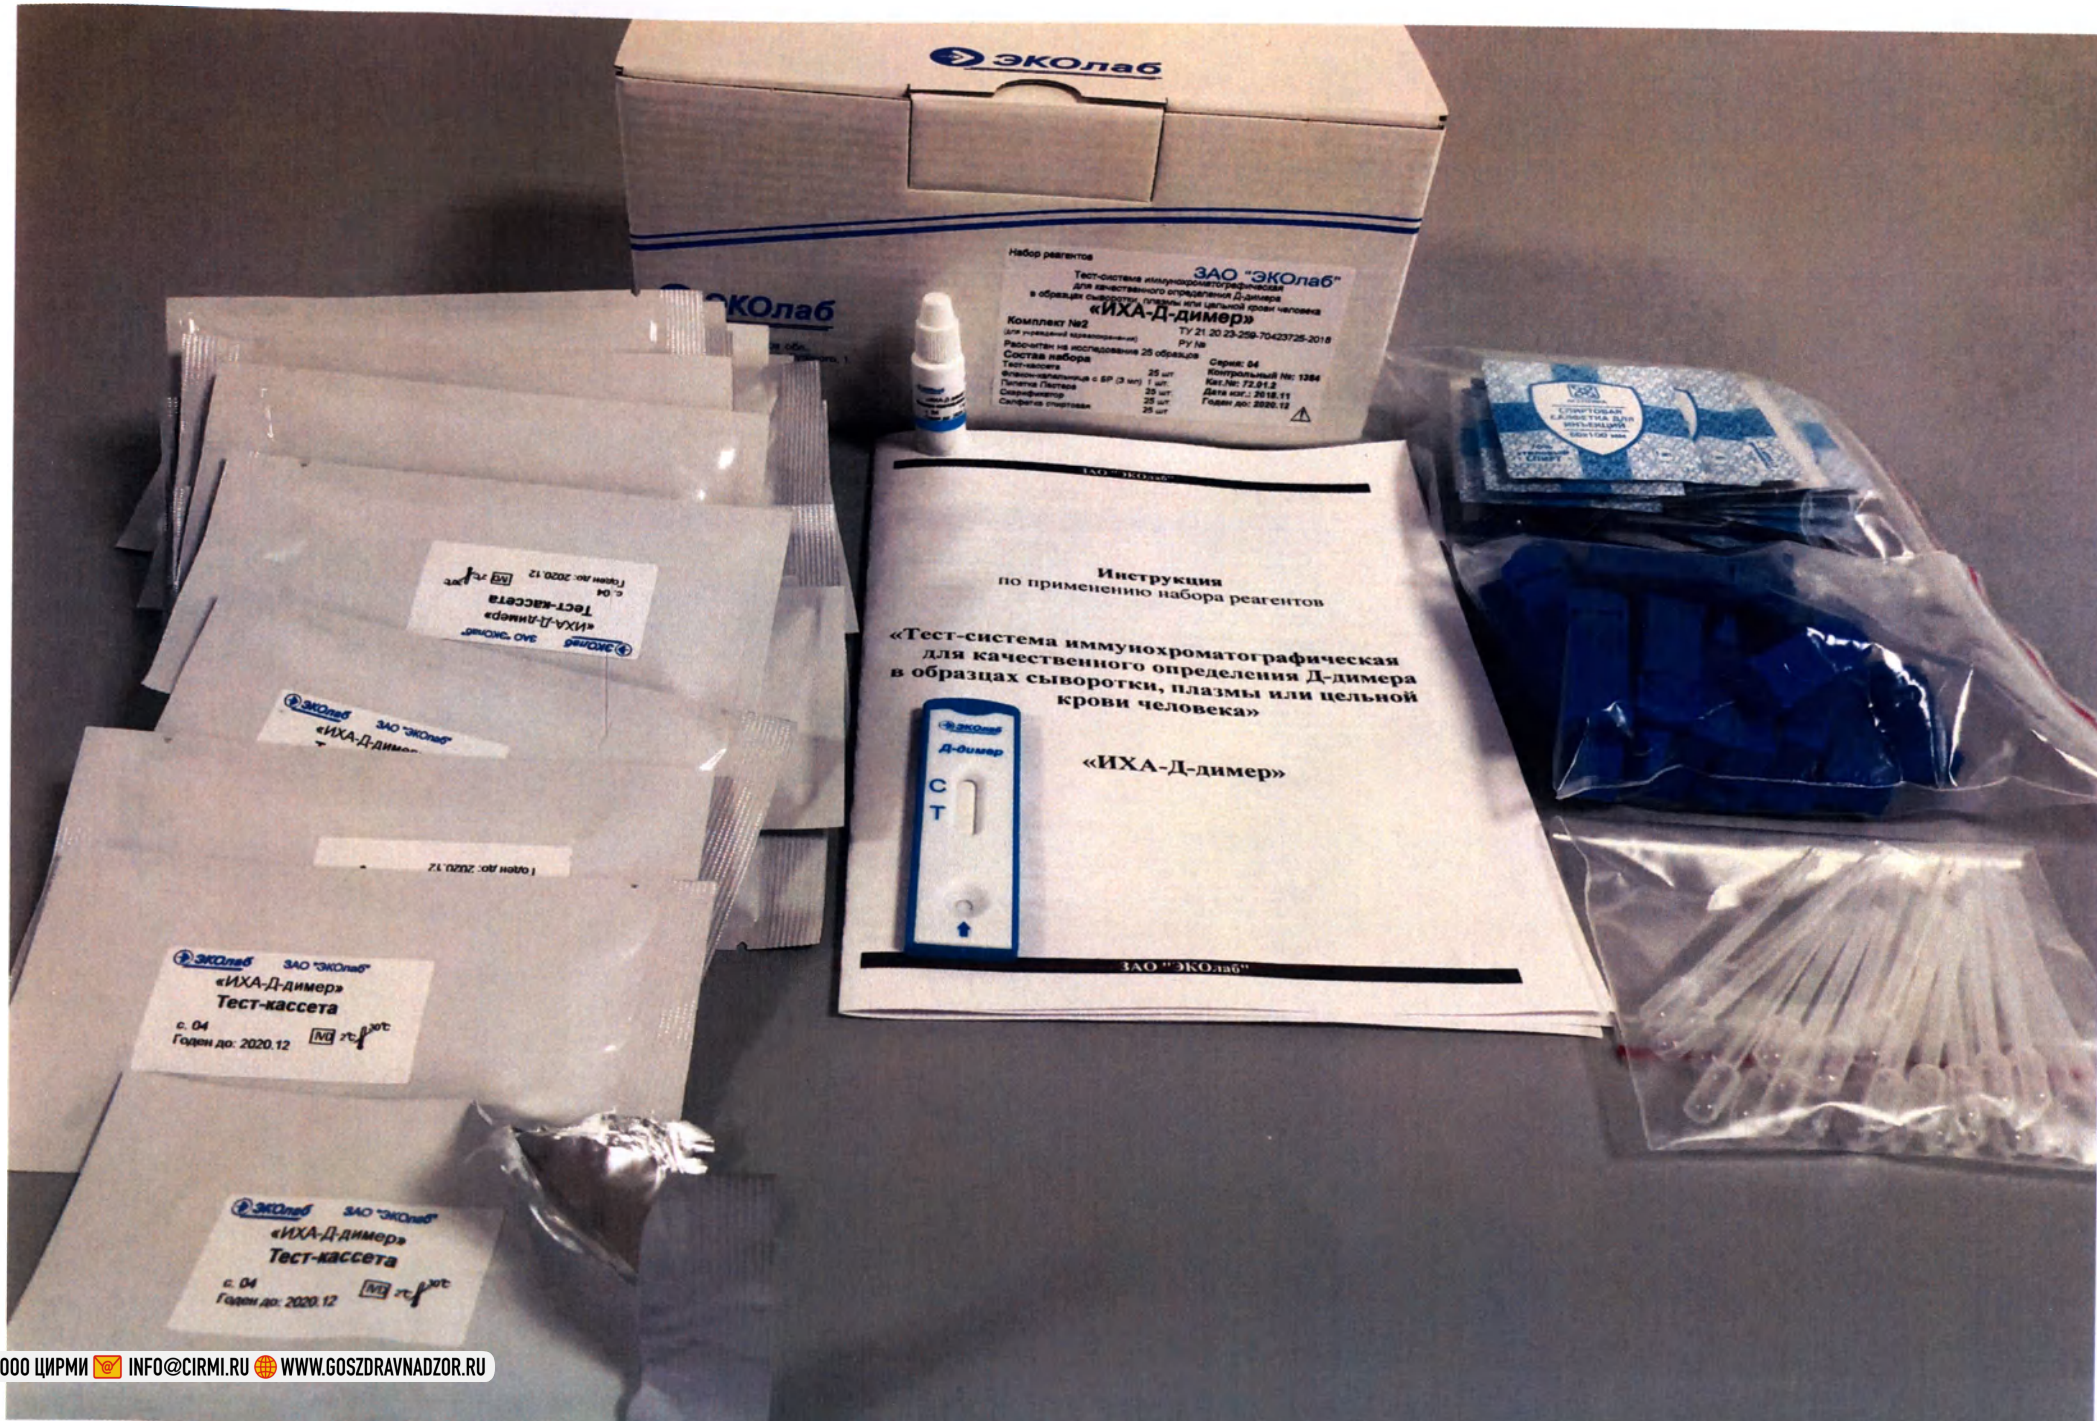

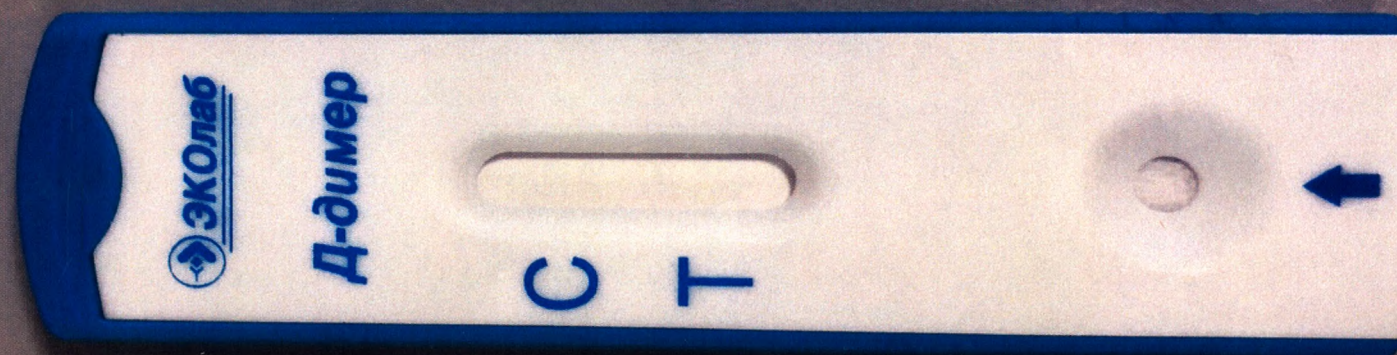

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
5 лист
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"30" 08 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
20 18 г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения Д-димера
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«ИХА-Д-димер»

Комплект №2

ТУ 21.20.23-259-70423725-2018

(для учреждений здравоохранения)

РУ №

Рассчитан на исследование 25 образцов

Состав набора

Тест-кассета	25 шт.
Флакон-капельница с БР (3 мл)	1 шт.
Пипетка Пастера	25 шт.
Скарификатор	25 шт.
Салфетка спиртовая	25 шт.

Серия: 02

Контрольный №: 1382



Кат.№: 72.01.2

Дата изг.: 2018.11

Годен до: 2020.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro» диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Начальник ОПР

Амелина Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«28» 12 20 18 г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения Д-димера
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«ИХА-Д-димер»

Комплект №1

ТУ 21.20.23-259-70423725-2018

(для учреждений здравоохранения)

РУ №

Рассчитан на исследование 10 образцов

Состав набора

Серия: 01

Контрольный №: 1381

Тест-кассета 10 шт.

Кат.№: 72.01.1

Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.

Дата изг.: 2018.11

Пипетка Пастера 10 шт.

Годен до: 2020.12

Скарификатор 10 шт.

Салфетка спиртовая 10 шт.



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Д-димер»

Тест-кассета

с. 01

Годен до: 2020.12



Начальник ОНР

Амелина Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"30" 2019 г.