



Фотография


Набора реагентов для определения антител к антигенам бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее в реакции агглютинации "Анти-Бактантиген-Тест" по ТУ 9388-027-70423725-2007
Salmonella paratyphi АН-реагент

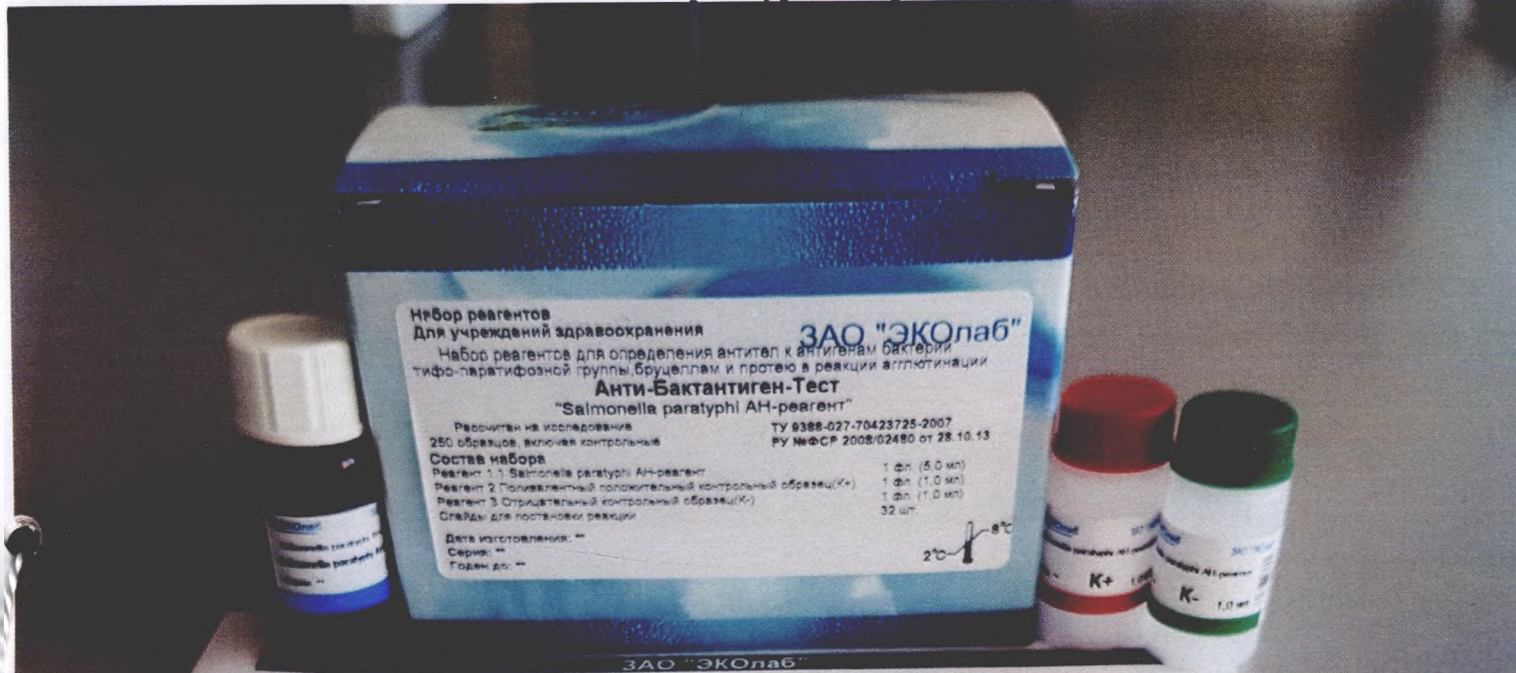

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

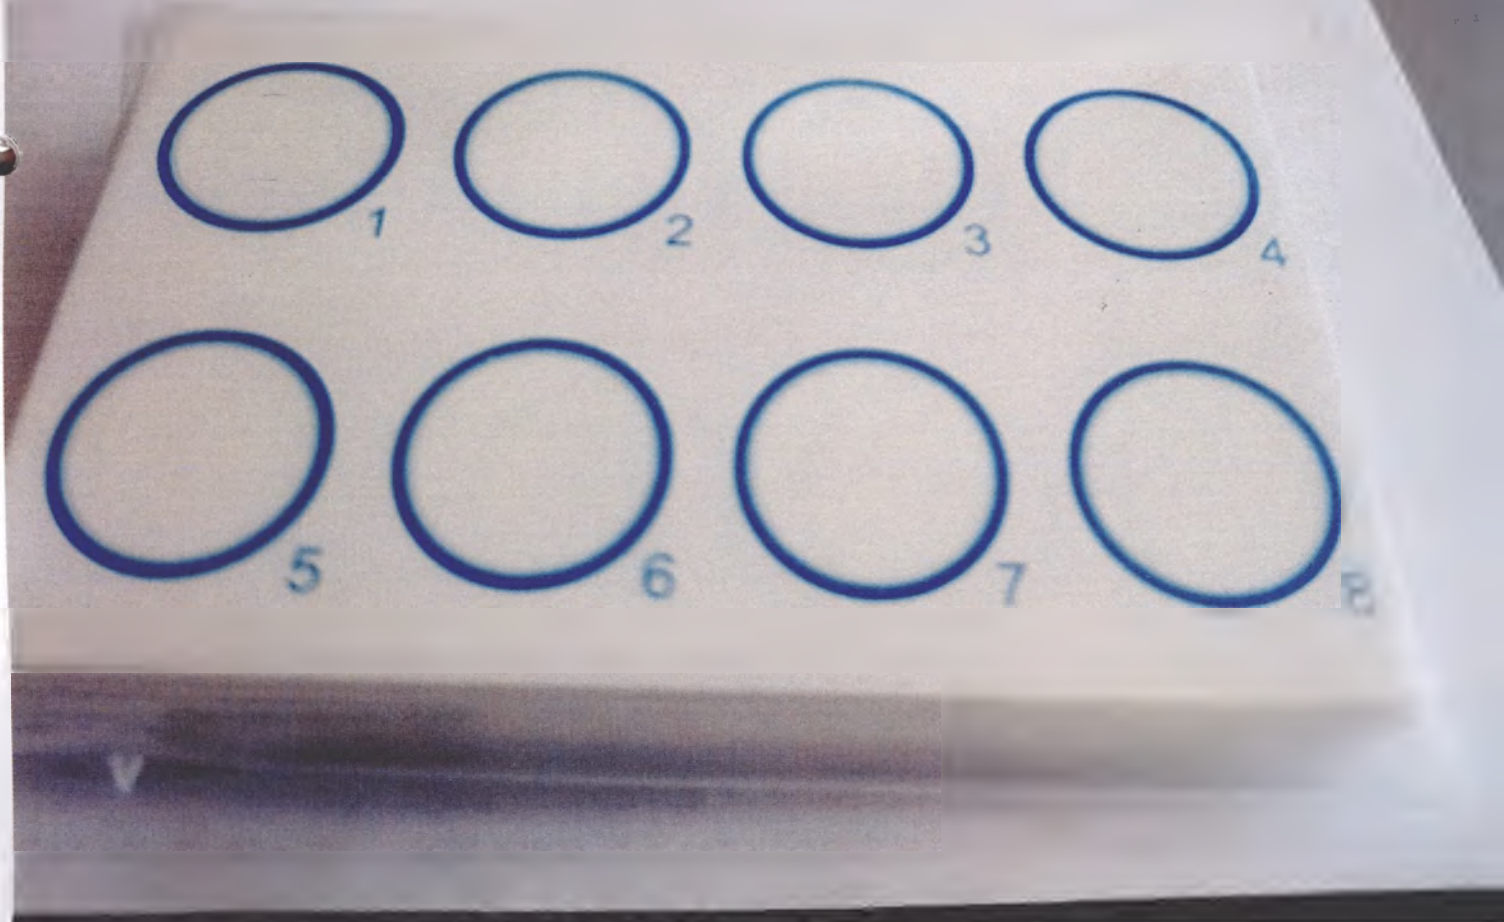


Salmonella paratyphi AO-реагент

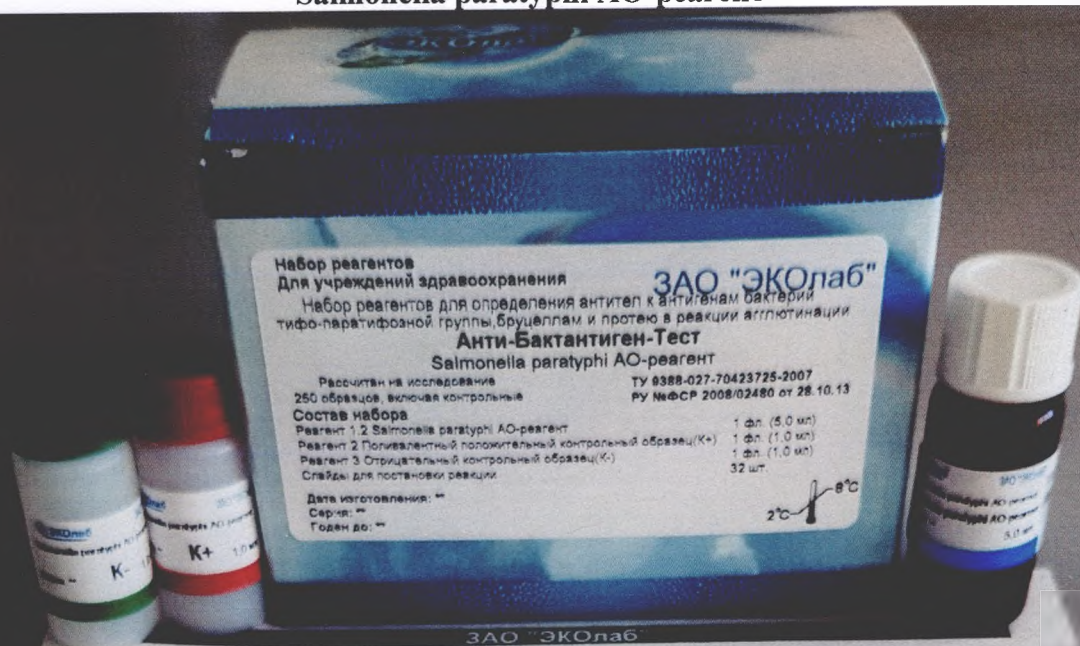


ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

РУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

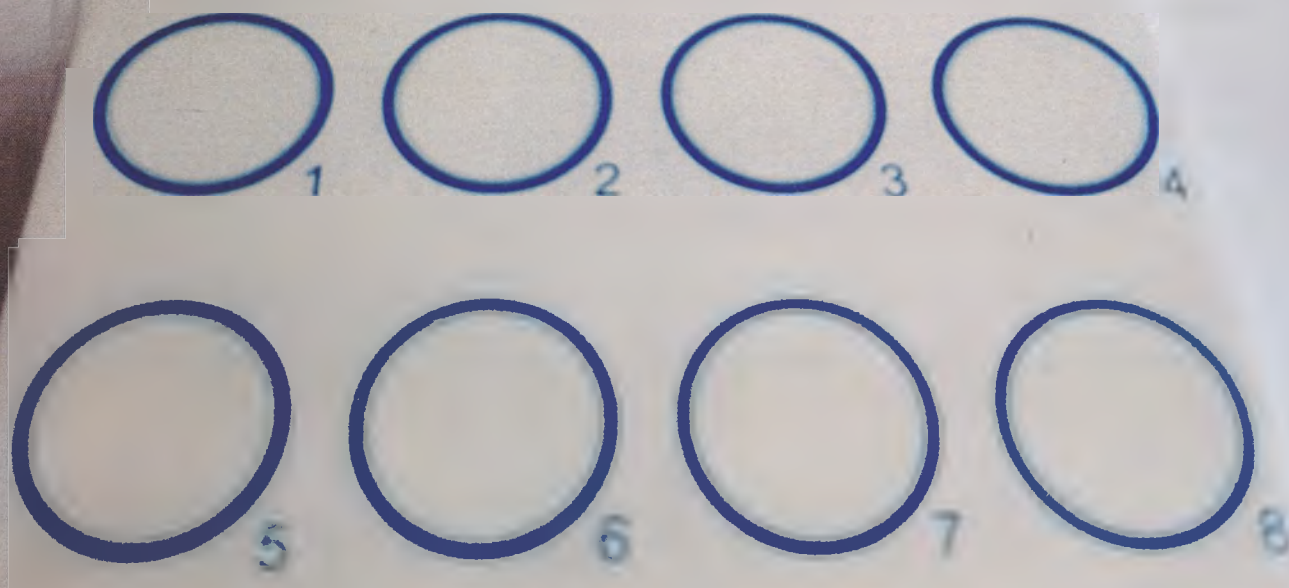


Salmonella paratyphi ВН-реагент

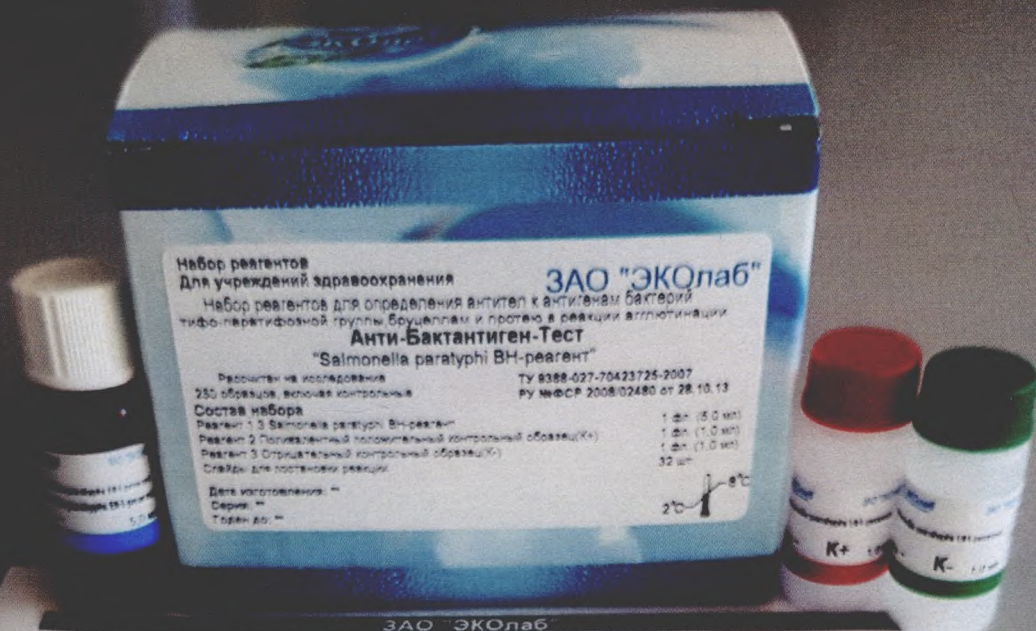


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

РУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

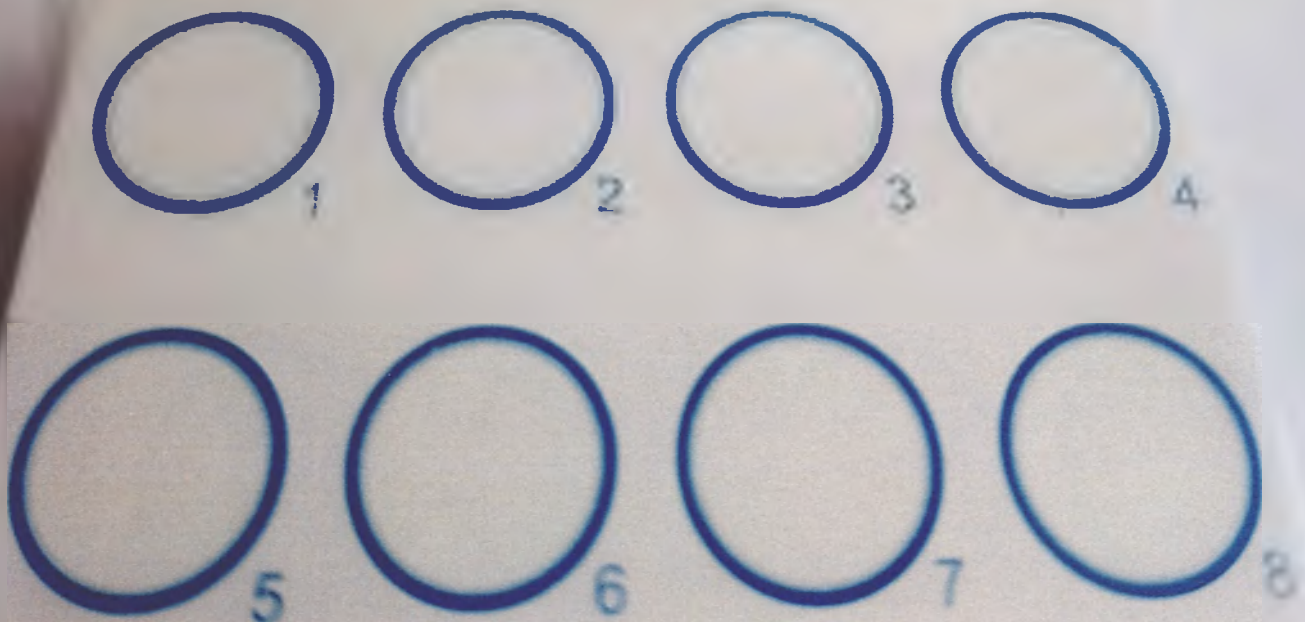

Salmonella paratyphi BO-реагент

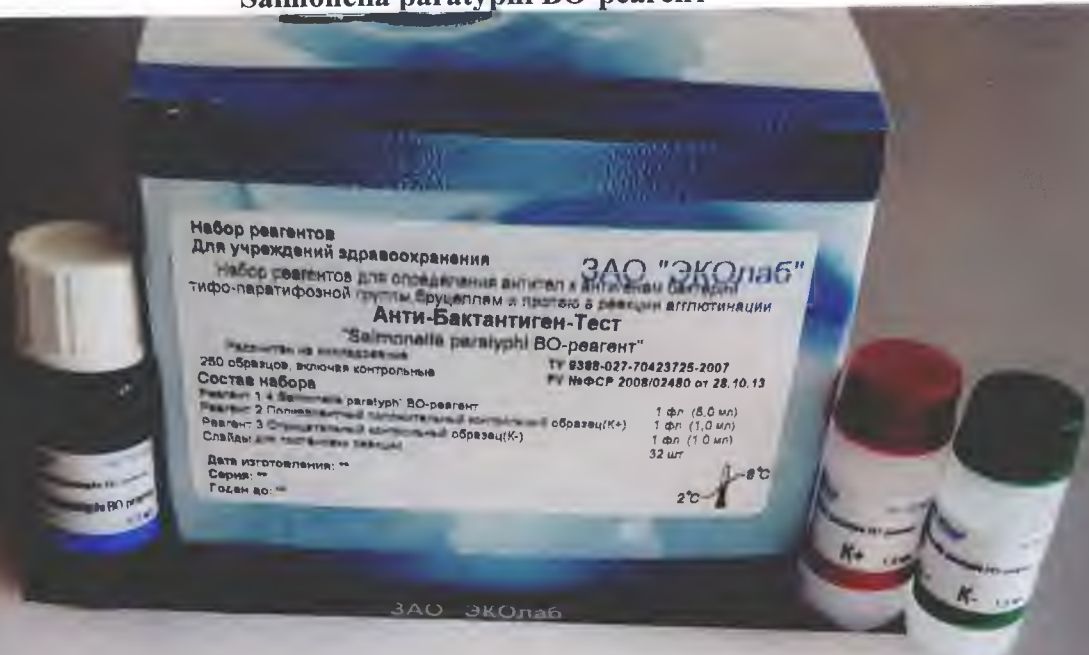


ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов для определения антител к антигенам бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протею в реакции агглютинации ("Анти-Бактантиген-Тест")

РУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г




Salmonella paratyphi CH-реагент

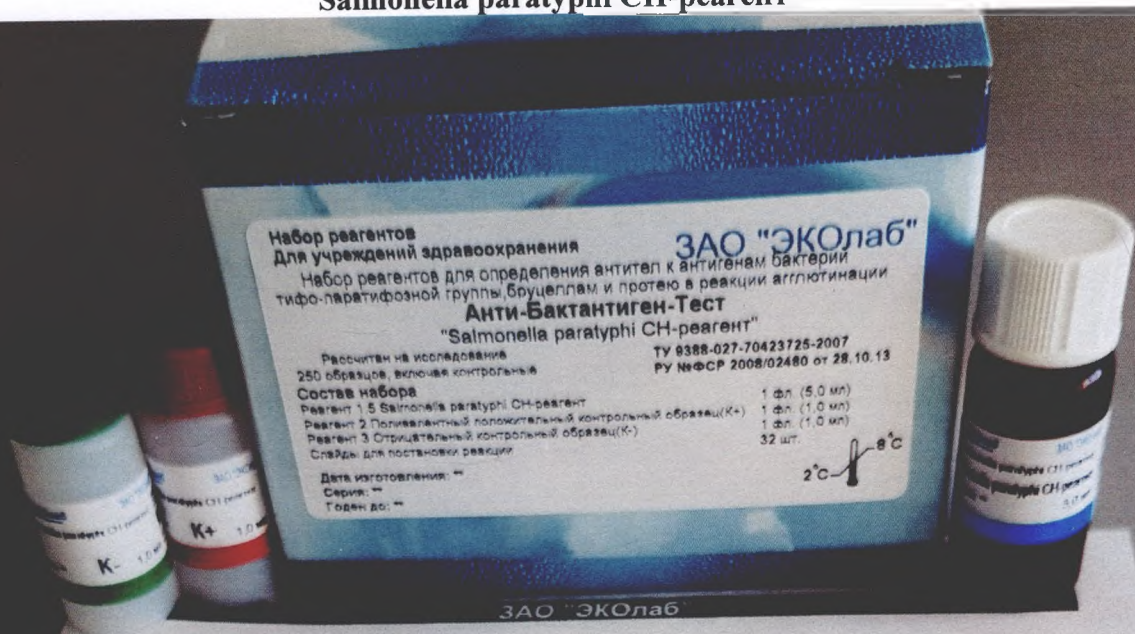

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее в реакции агглютинации ("Анти-Бактантиген-Тест")

ПУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

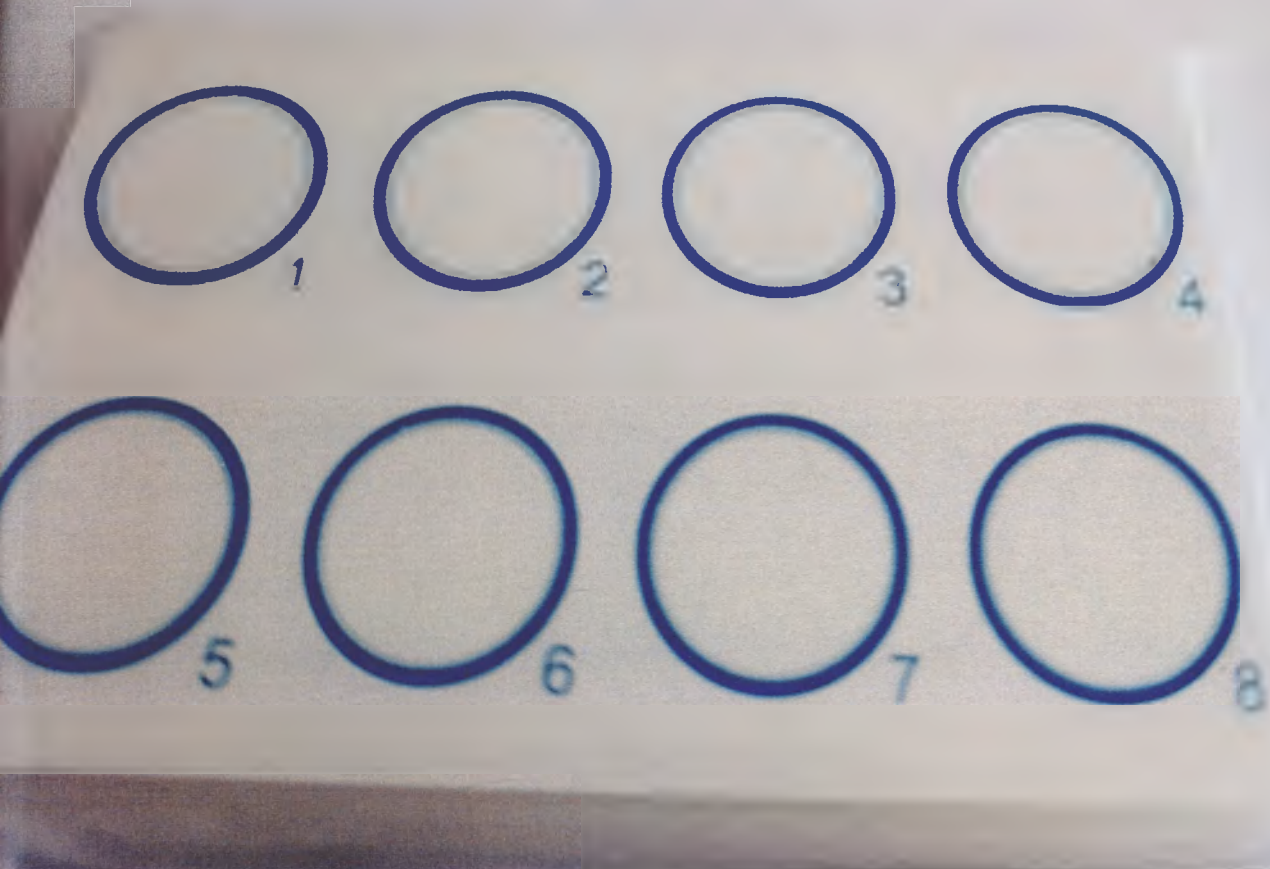


Salmonella paratyphi CO-реагент




ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

ПУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

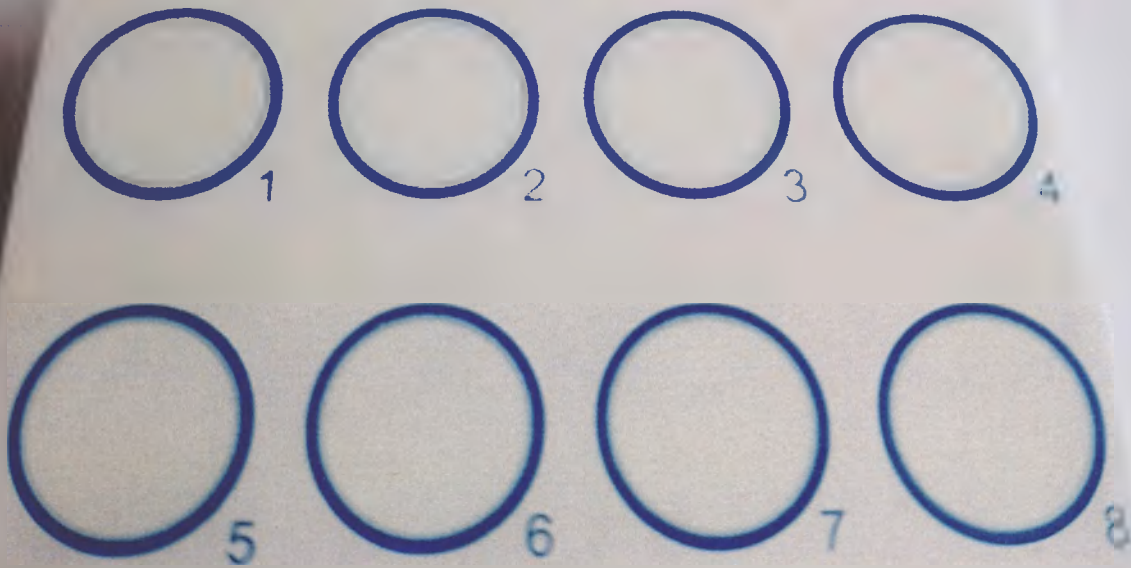


Salmonella typhi H-реакгент

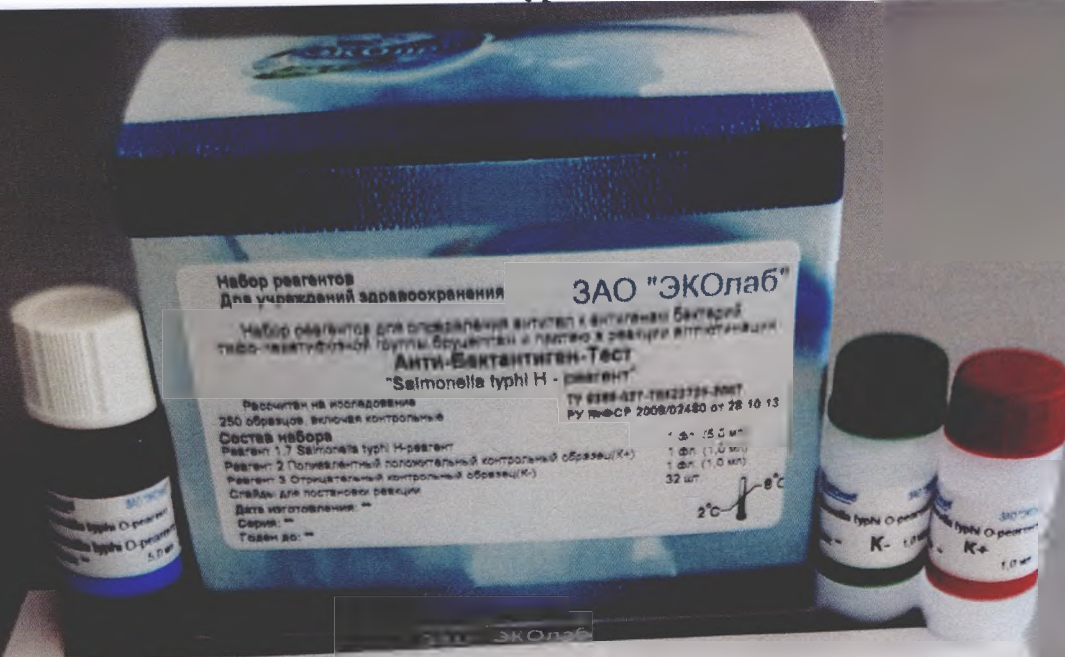

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протею
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

ПУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

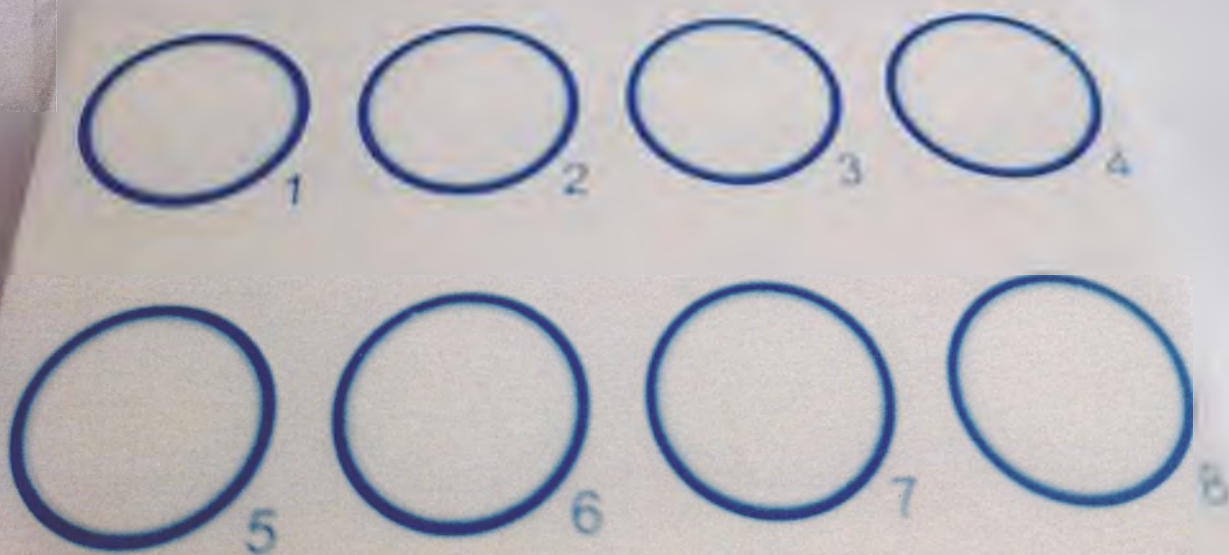


Salmonella typhi O-реагент

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
ЗАО "ЭКОлаб"
Набор реагентов для определения антител к антигенам бактерий
тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее в реакции агглютинации
Анти-Бактантиген-Тест
"Salmonella typhi O - реагент"
Рассчитан на исследование
250 образцов, включая контрольные
ТУ 8388-027-70423725-2007
ПУ №ФСР 2008/02480 от 28.10.13
Состав набора
Реагент 1 & Salmonella typhi O-реагент 1 фл. (5,0 мл)
Реагент 2 Поливалентный положительный контрольный образец (K+) 1 фл. (1,0 мл)
Реагент 3 Стрицательный контрольный образец (K-) 1 фл. (1,0 мл)
Слайды для постановки реакции 32 шт.
Дата изготовления: --
Серия: --
Годен до: --
2°C 8°C


ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

ПУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

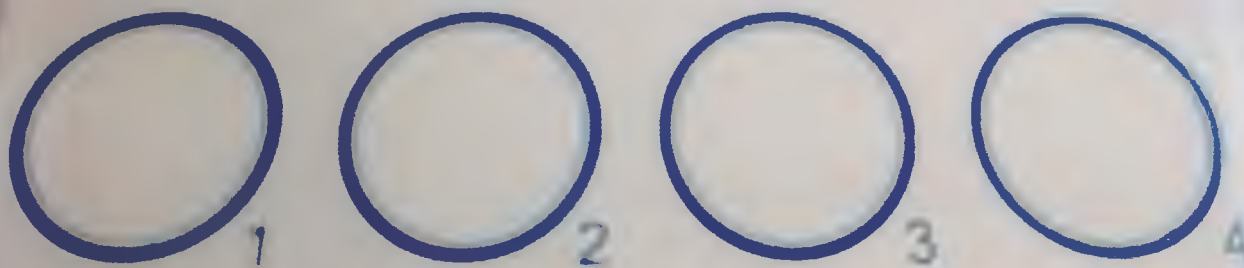

Brucella-реагент

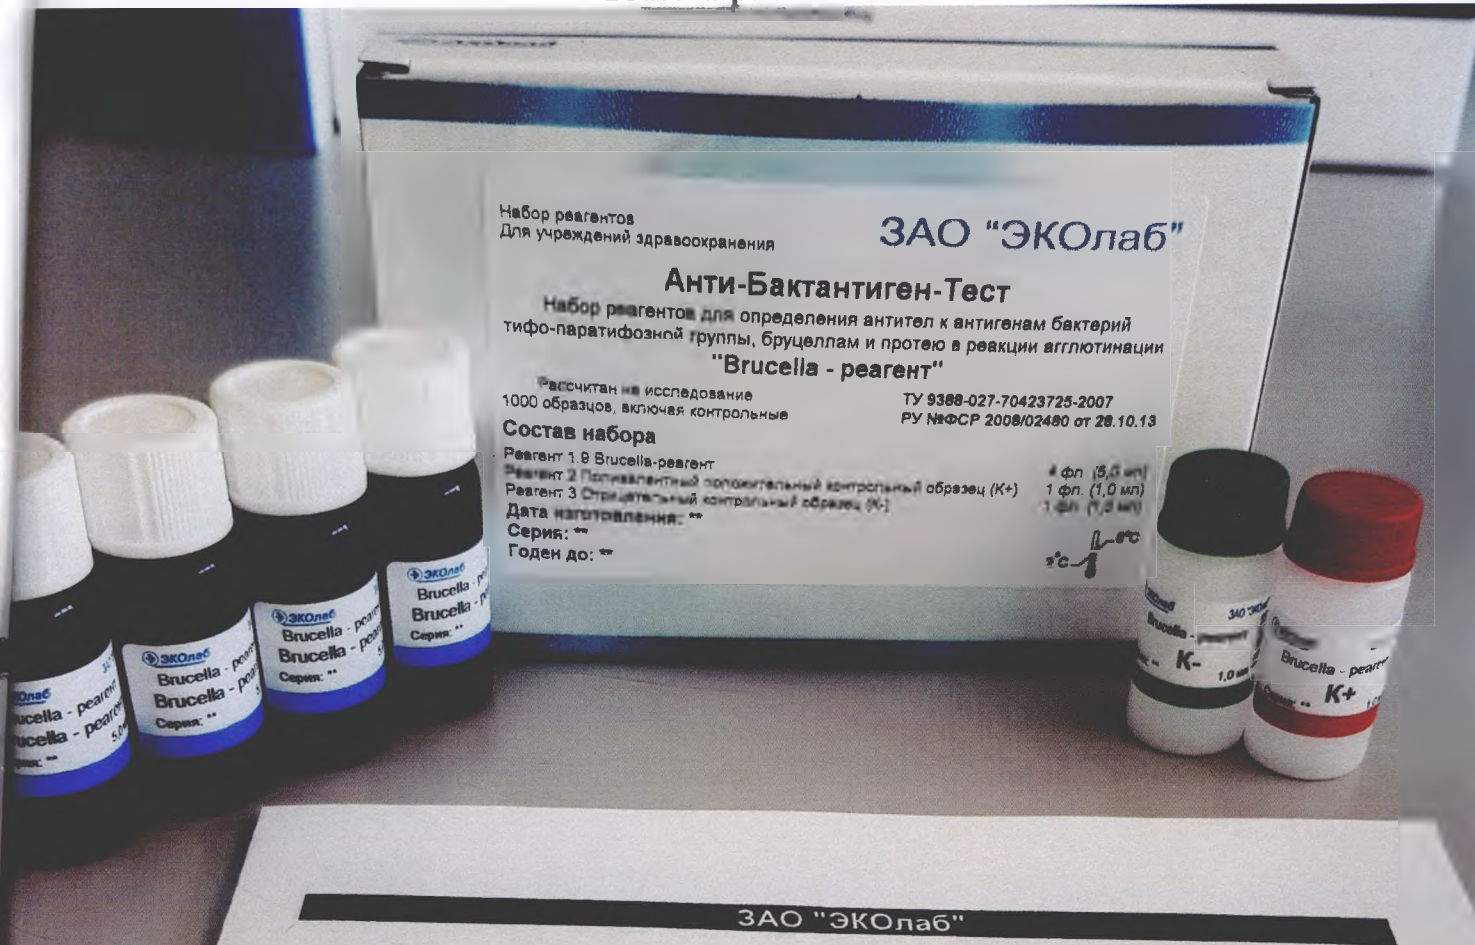

ЗАО "ЭКОлаб"


ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протею
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

ПУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

«Brucella-реагент»


Proteus OX2-реагент

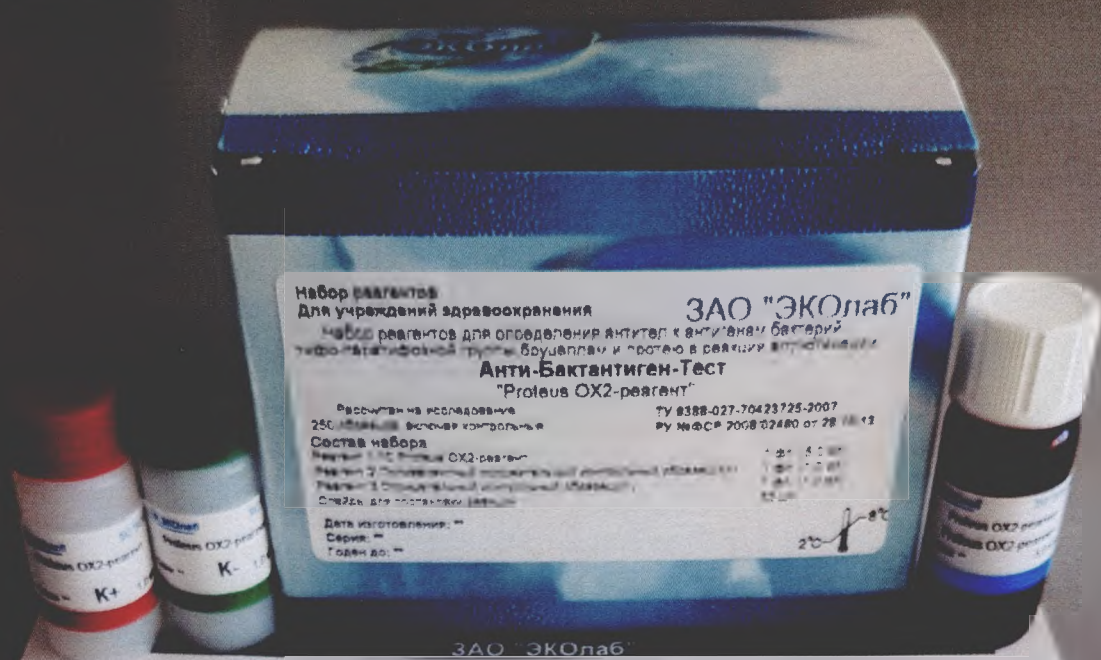


ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протею в реакции агглютинации ("Анти-Бактантиген-Тест")

ПУ № ФСР 2008/02480 от 28 октября 2013 г

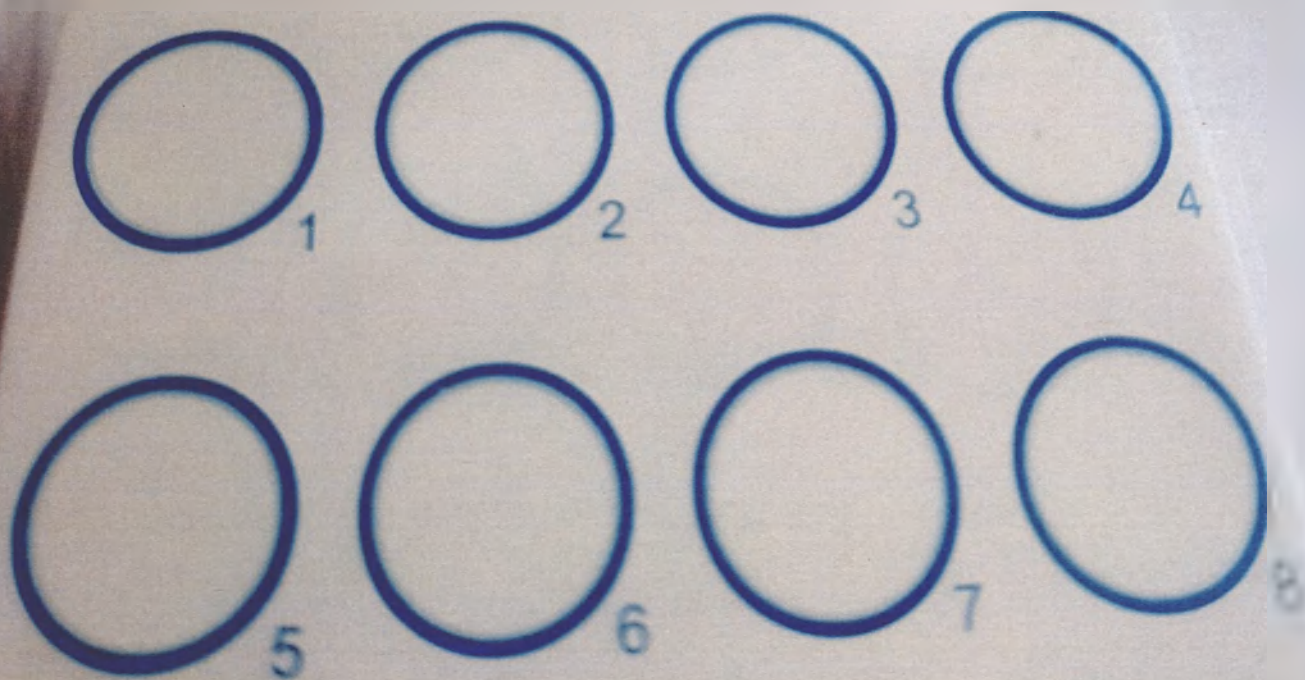


Proteus OX19-реагент

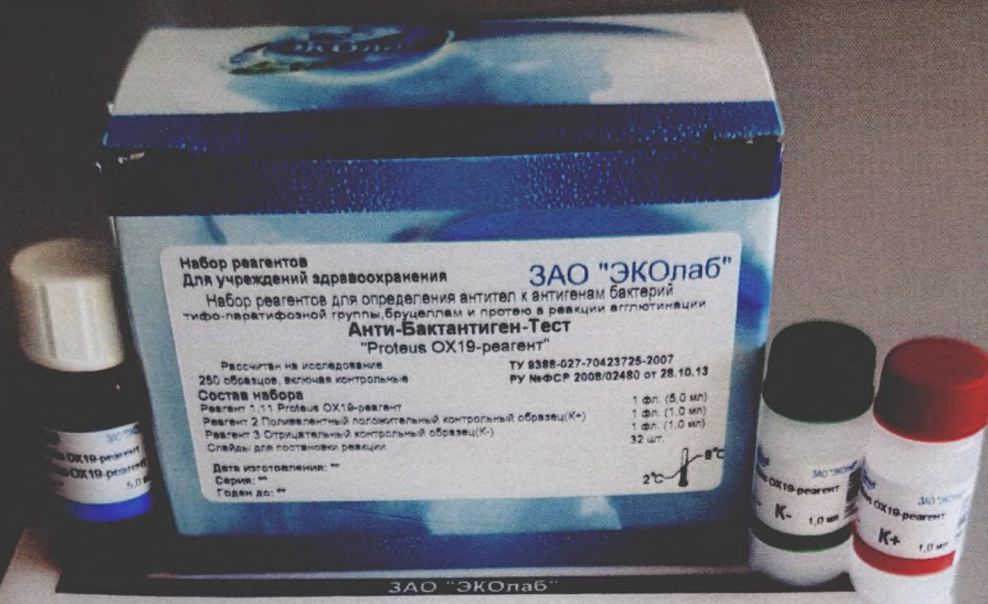


ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протею
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

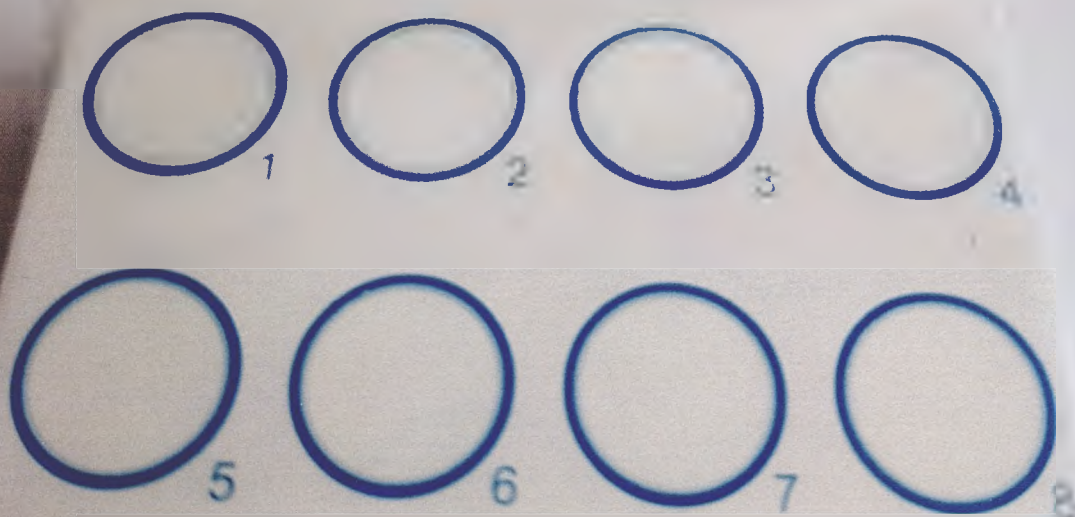


ЗАО "ЭКОлаб"

Proteus OXK-реагент

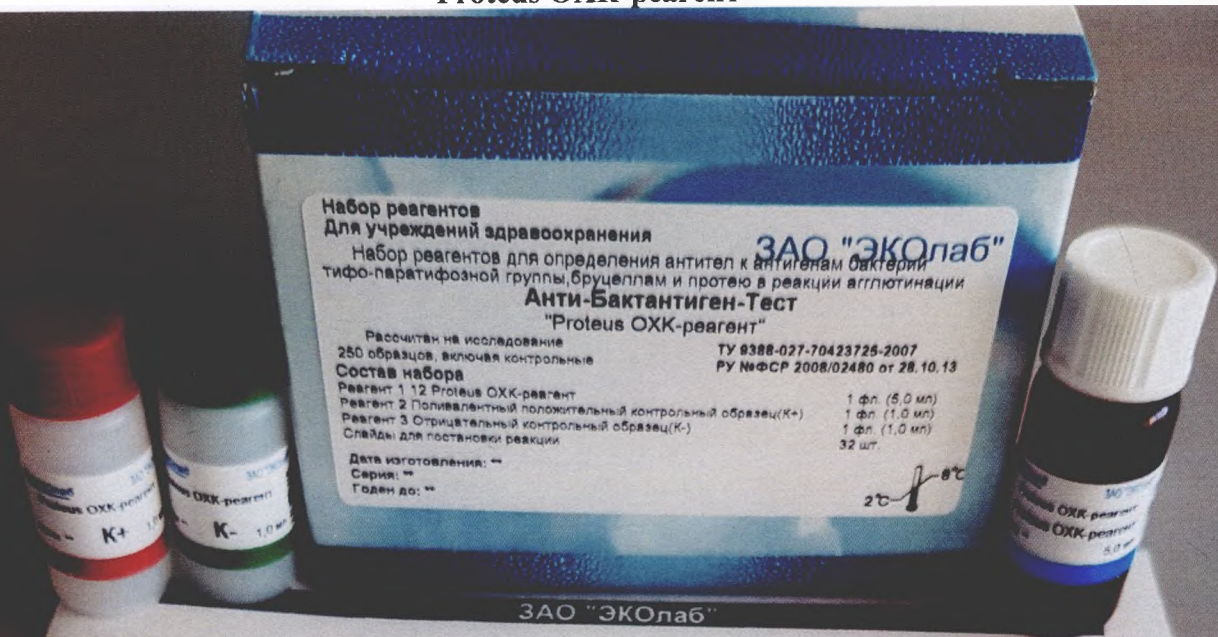


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения антител к антигенам
бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протее
в реакции агглютинации
("Анти-Бактантиген-Тест")

ТУ 9388-027-70423725-2007 от 28 октября 2013 г

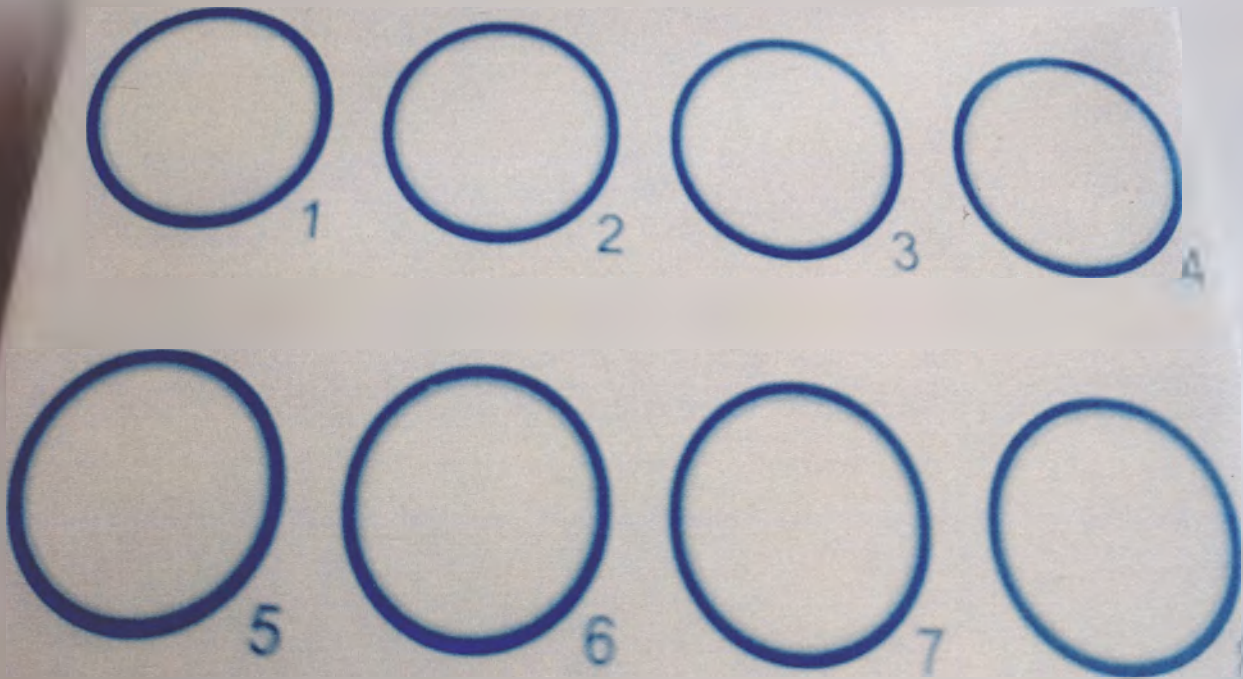

Макет упаковки

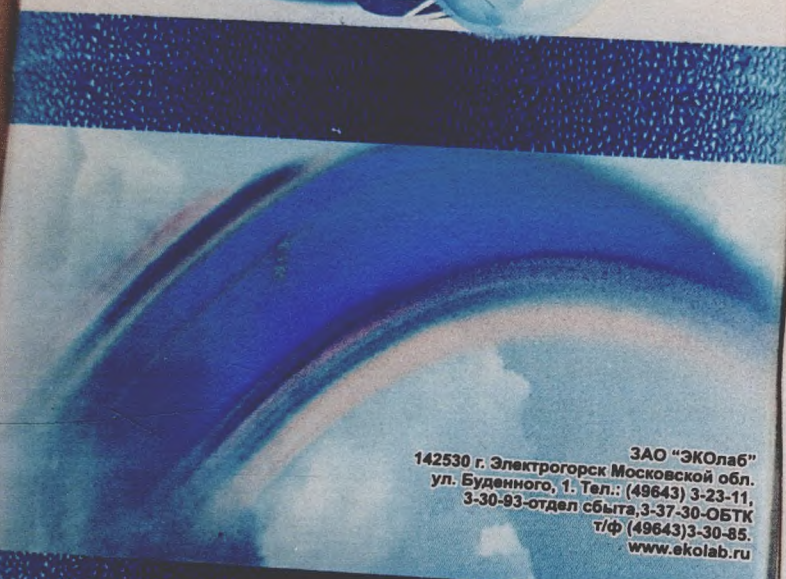

ЗАО "ЭКОЛАБ"
142530 г. Электрогорск Московской обл.
ул. Буденного, 1. Тел.: (49643) 3-23-11,
3-30-93-отдел сбыта, 3-37-30-ОБТК
т/ф (49643)3-30-85.
www.ekolab.ru



Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
международным стандартам



ISO 9001 : 2015
№ 2007 / 28641.6



ISO 13485 : 2003
№ 2007 / 28642.4

Генеральный директор ЗАО "ЭКОЛАБ"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

431 лист 28
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"17" 05 2018 г.