



**Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ
АГГЛЮТИНАЦИИ»**

Комплект №1/1, Исполнение 1

Сыворотки менингококковые диагностические серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E, сухие

серия 01/21 от 2021.01.12

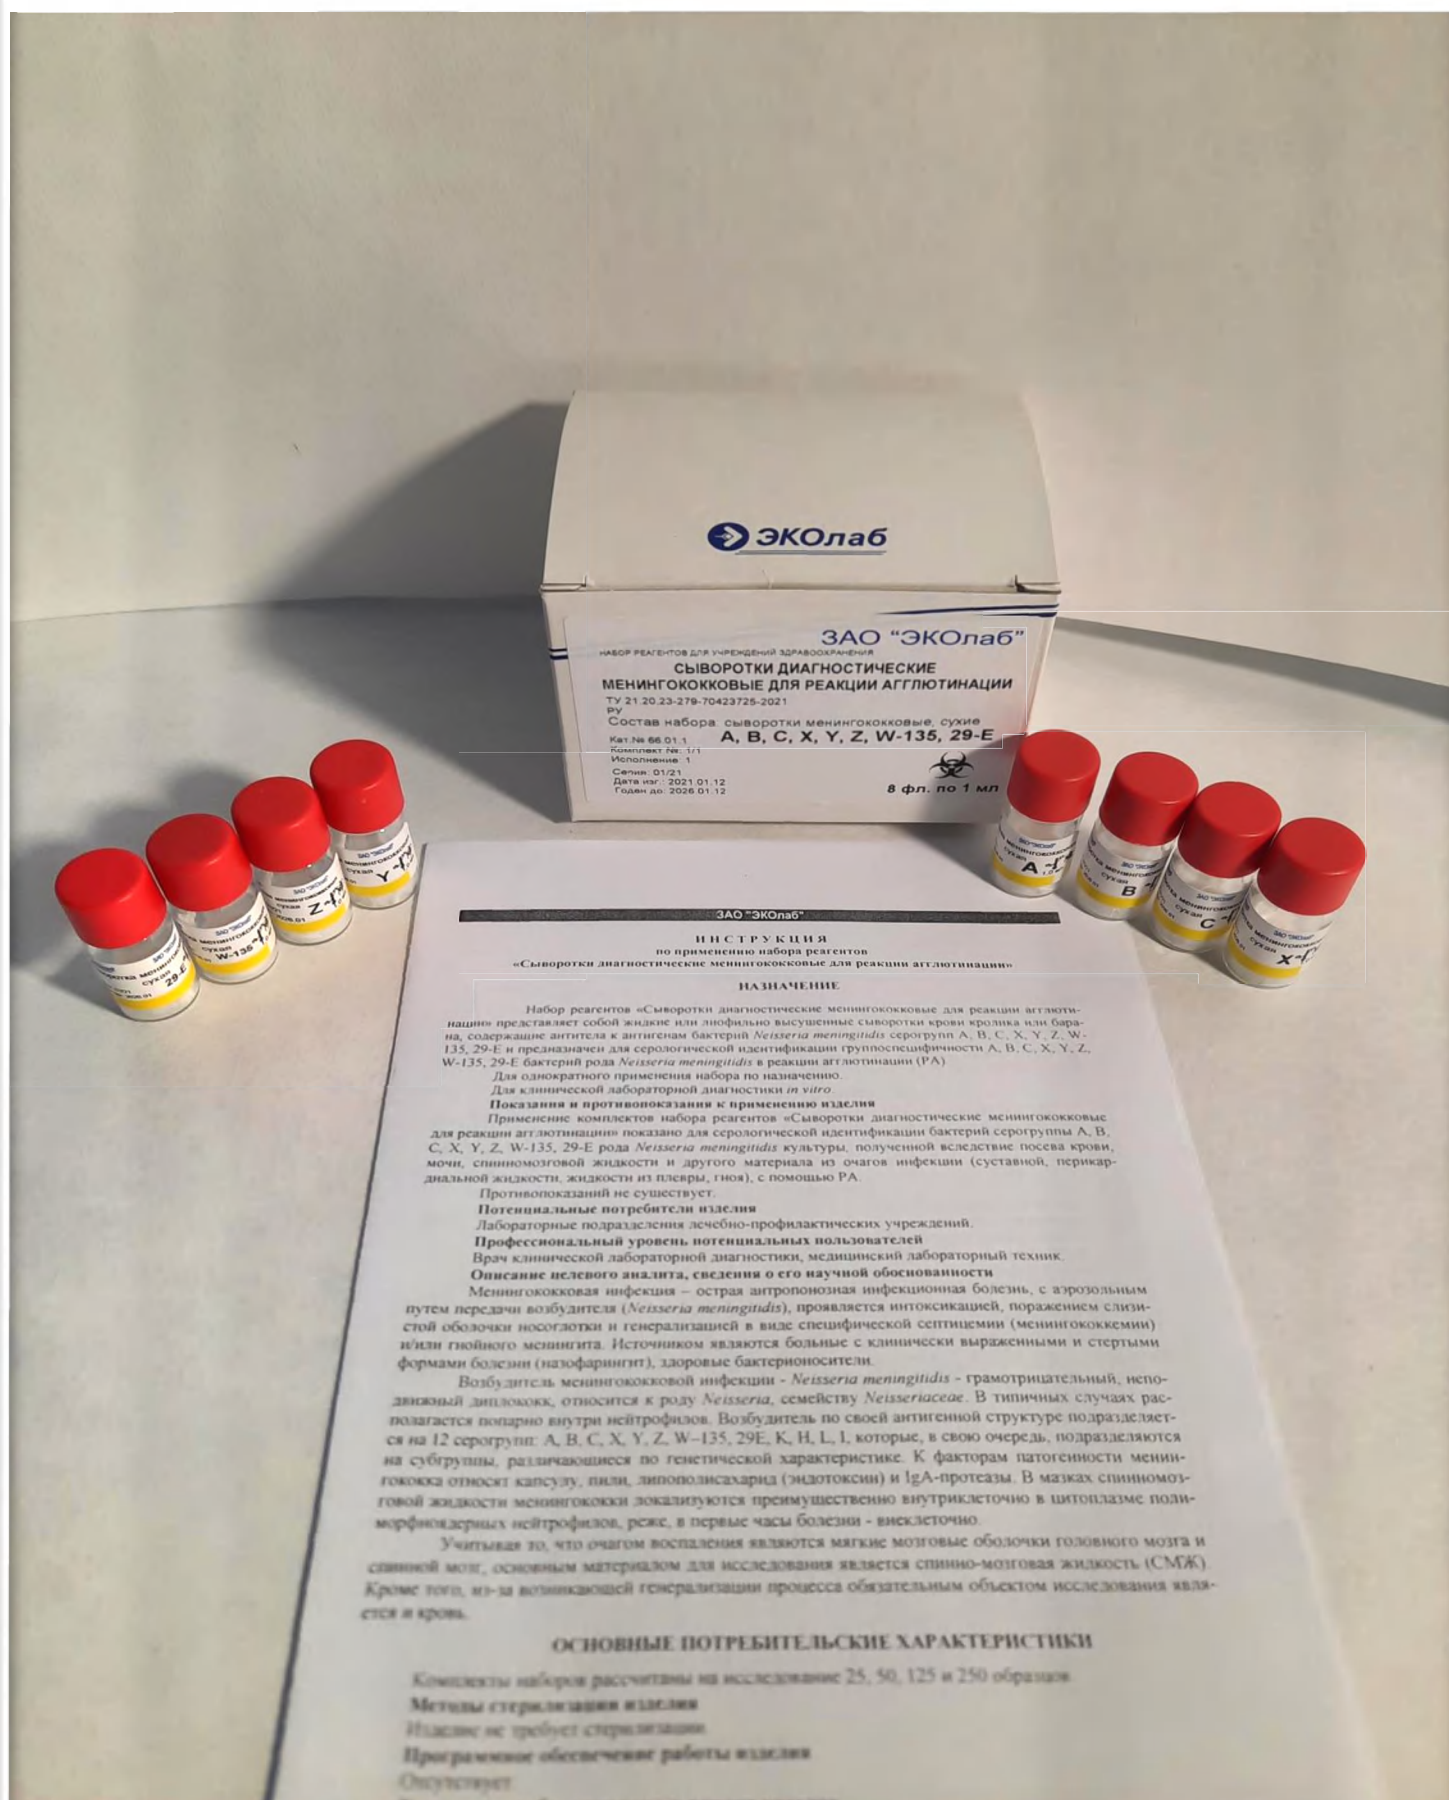

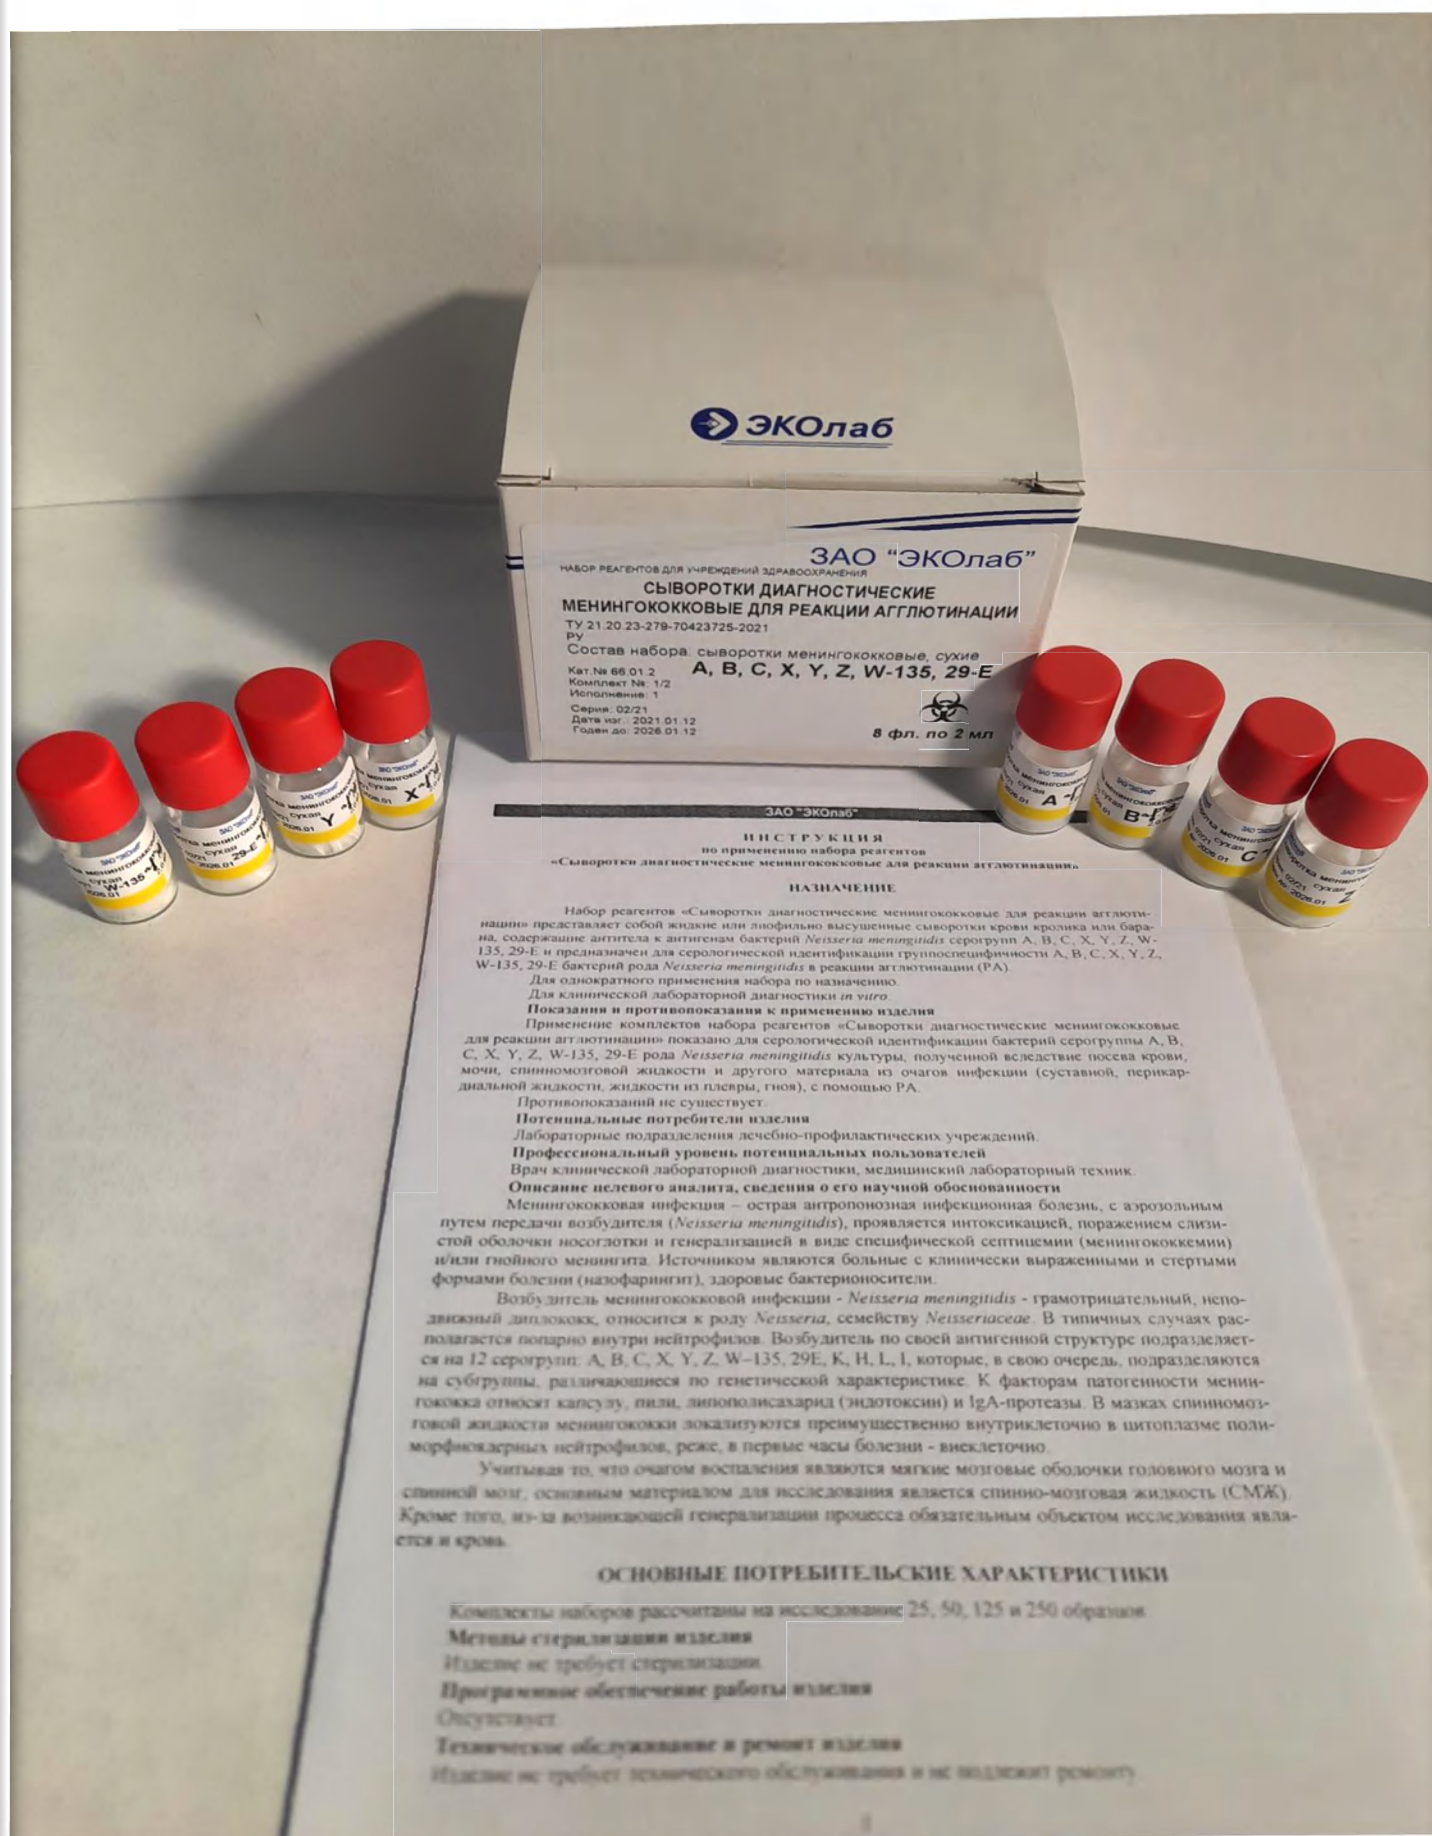

Комплект №1/3, Исполнение 1

Сыворотки менингококковые диагностические серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E, жидкие

серия 03/21 от 2021.01.12




Комплект №1/4, Исполнение 1

Сыворотки менингококковые диагностические серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E, жидкие
серия 04/21 от 2021.01.12



Комплект №2/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая А, сухая

серия 05/21 от 2021.01.12

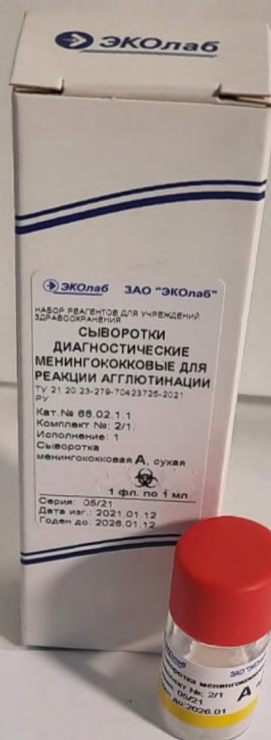

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.


Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции - *Neisseria meningitidis* - грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*. В типичных случаях расщепляет желатину, не ферментирует сахара. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяет-


Комплект №2/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая А, сухая

серия 06/21 от 2021.01.12

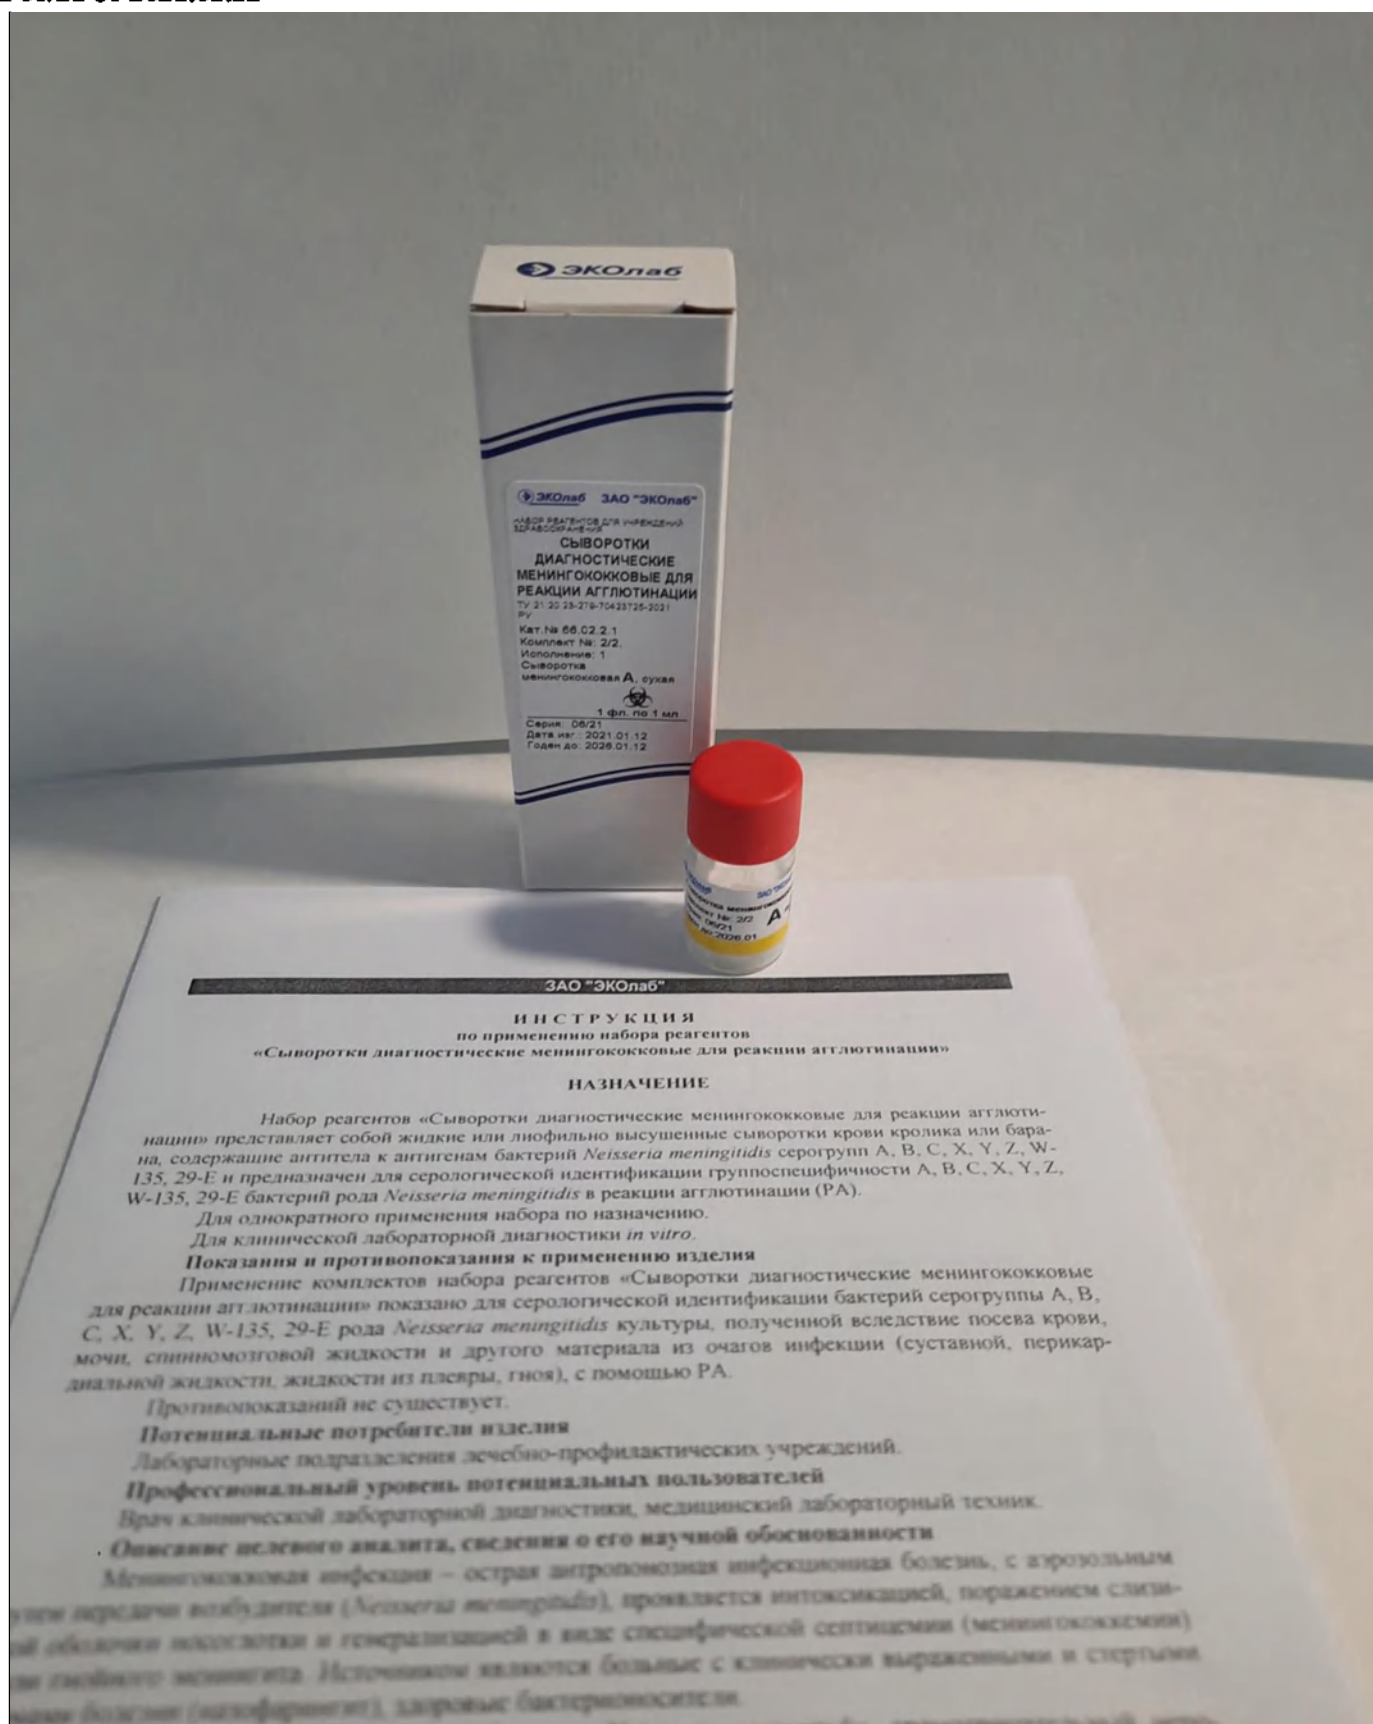


Комплект №2/3, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая А, жидкая

серия 07/21 от 2021.01.12

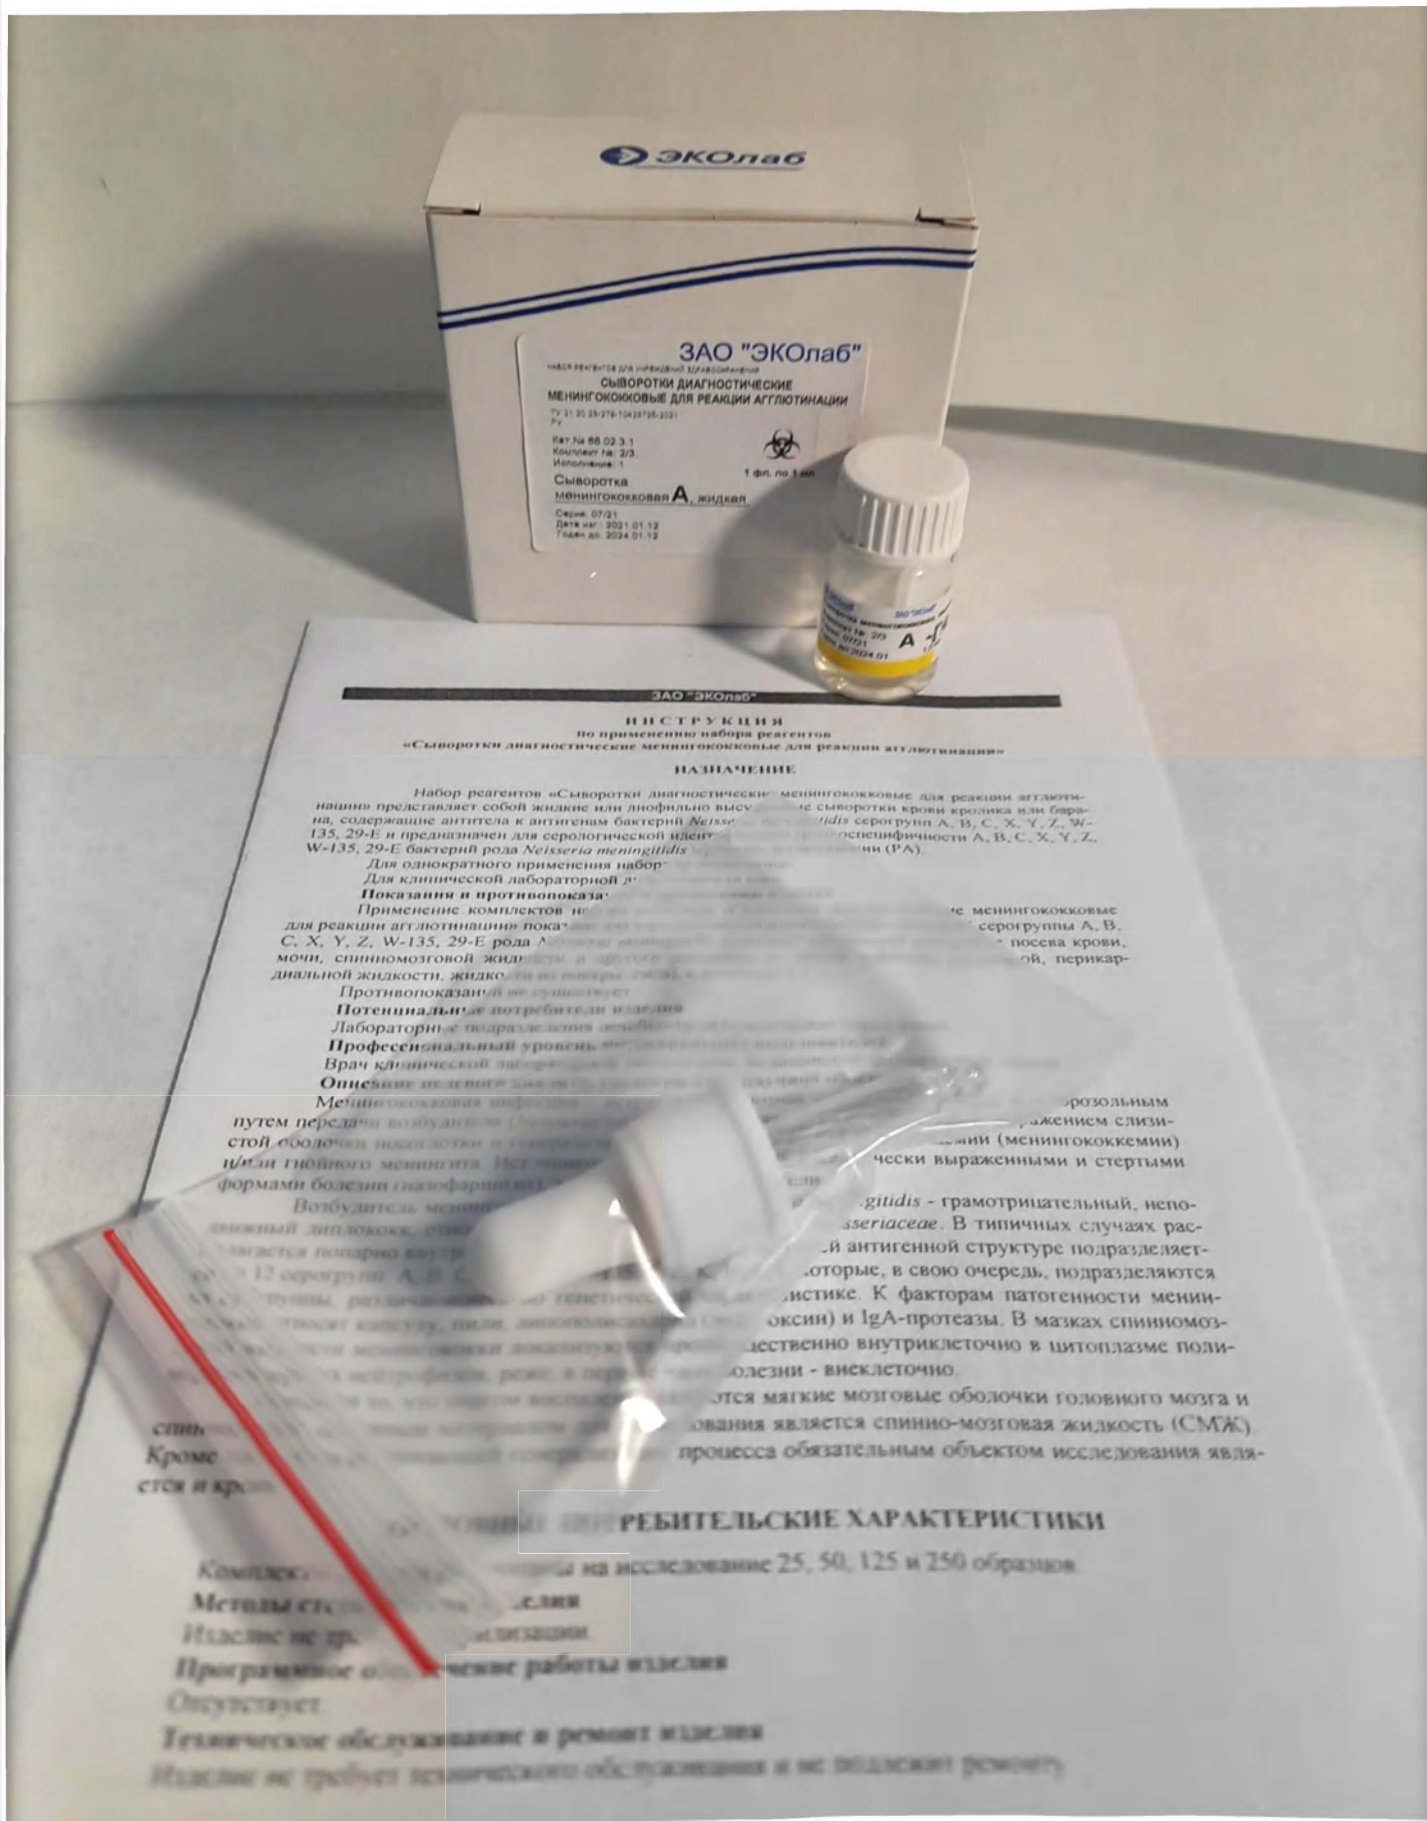


Комплект №2/4, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая А, жидкая

серия 08/21 от 2021.01.12

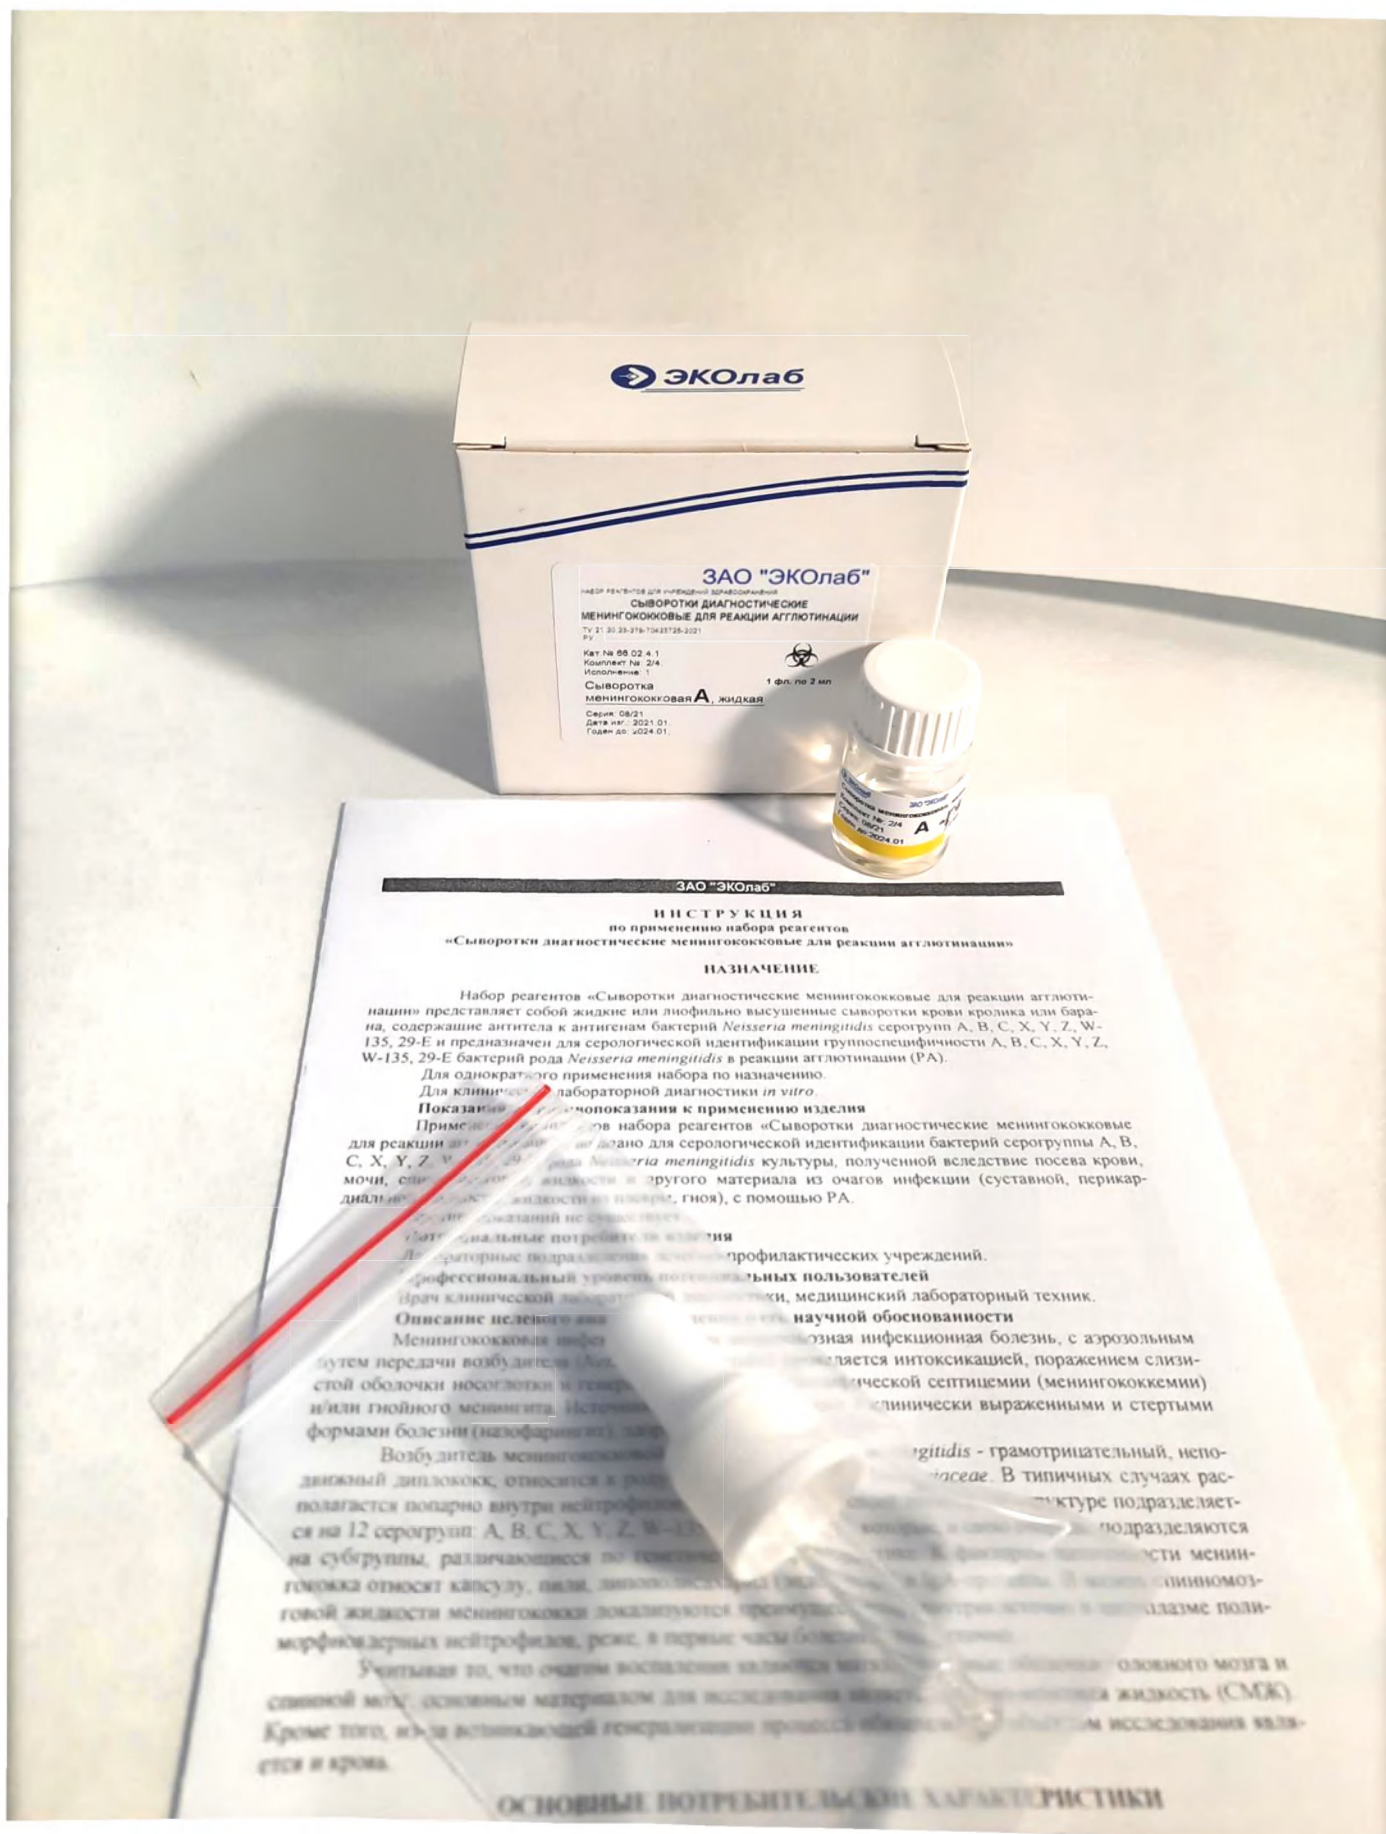


Комплект №3/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая В, сухая

серия 09/21 от 2021.01.12

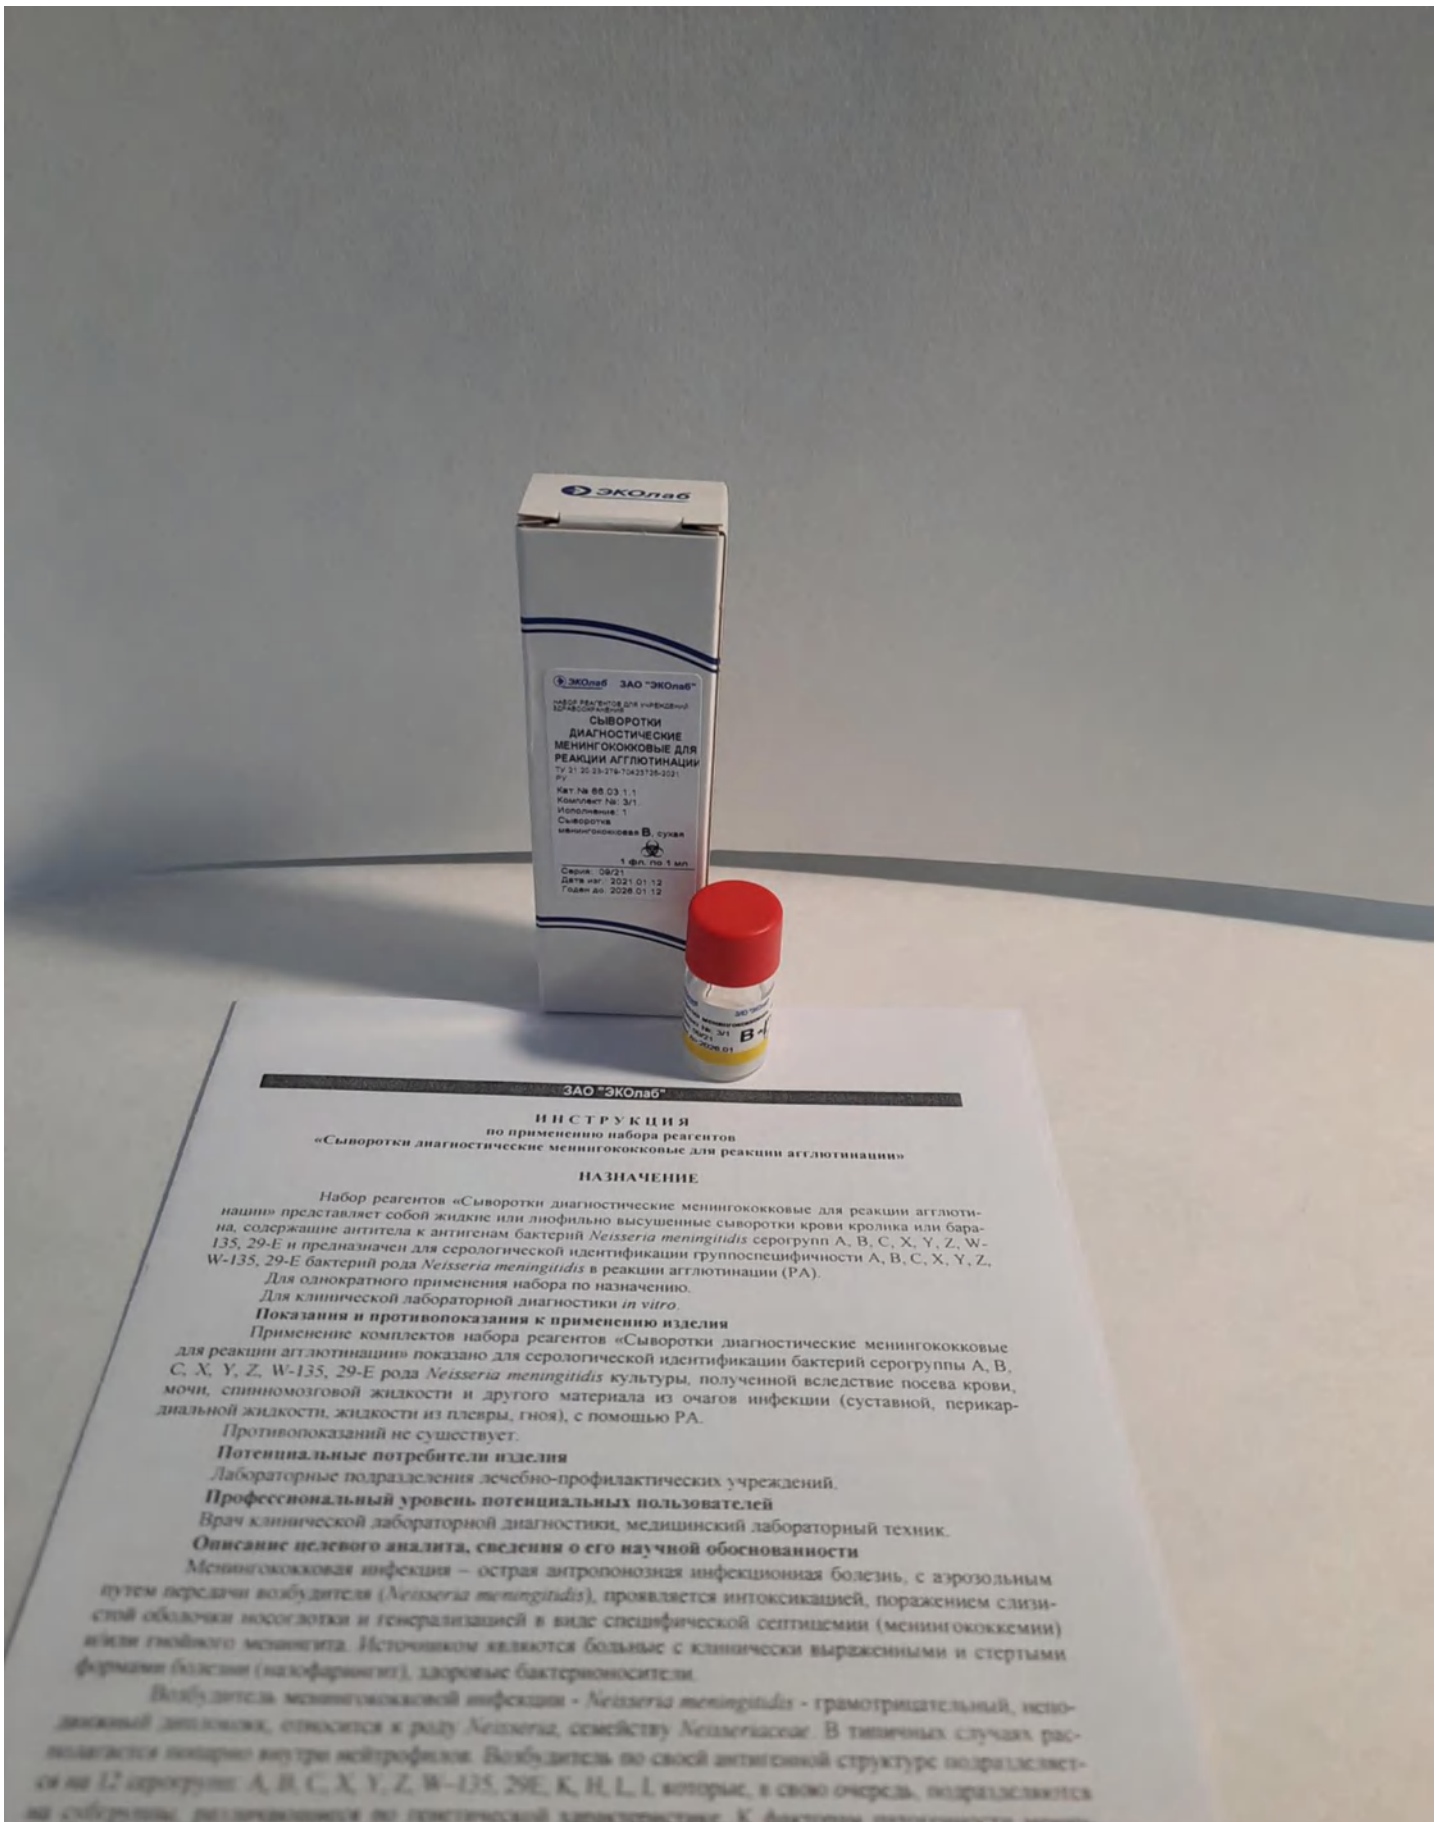


Комплект №3/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая В, сухая

серия 10/21 от 2021.01.12

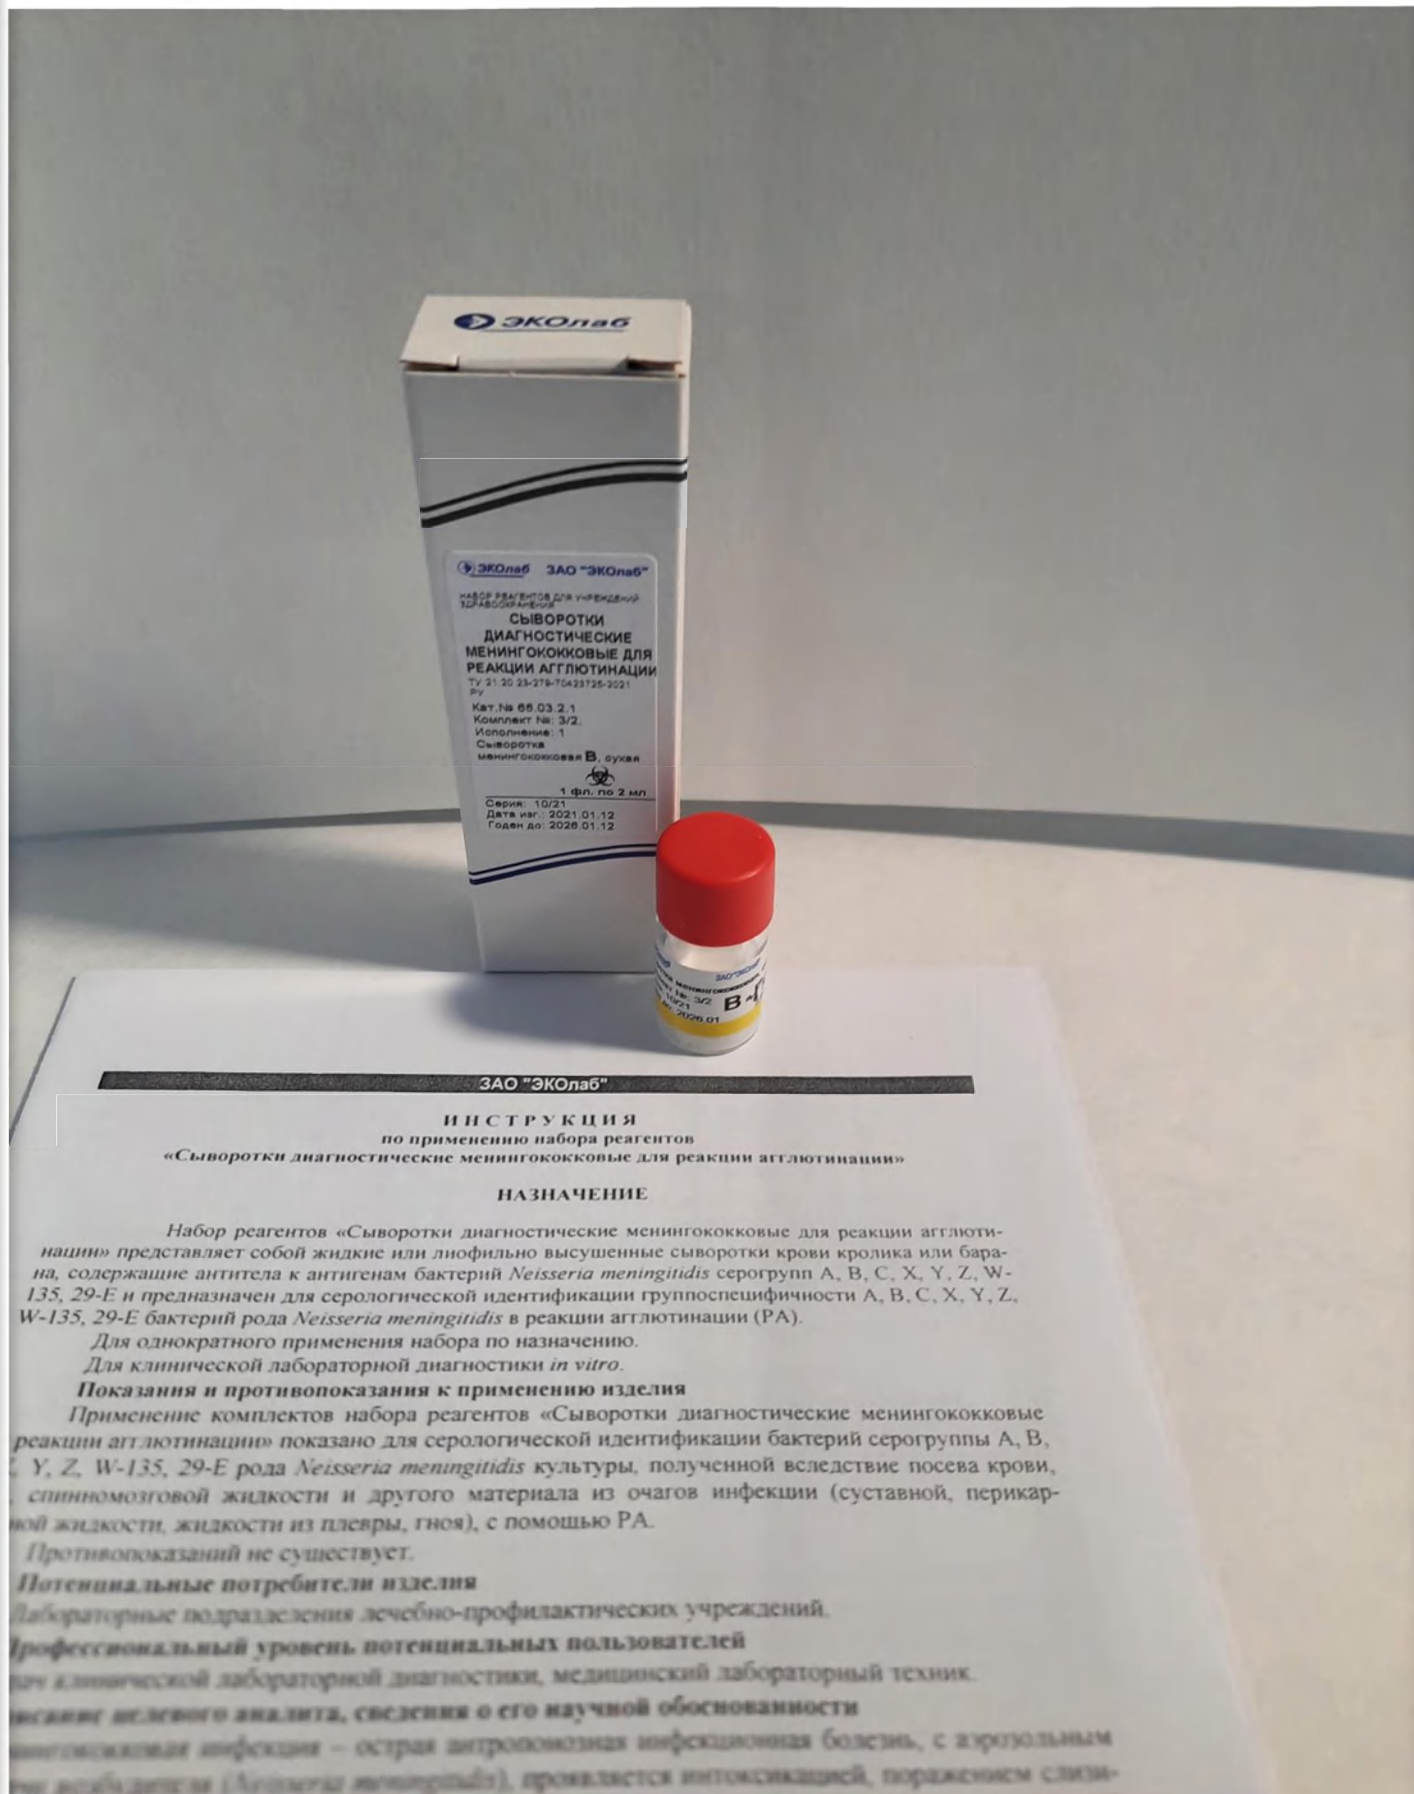


Комплект №3/3, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая В, жидкая

серия 11/21 от 2021.01.12

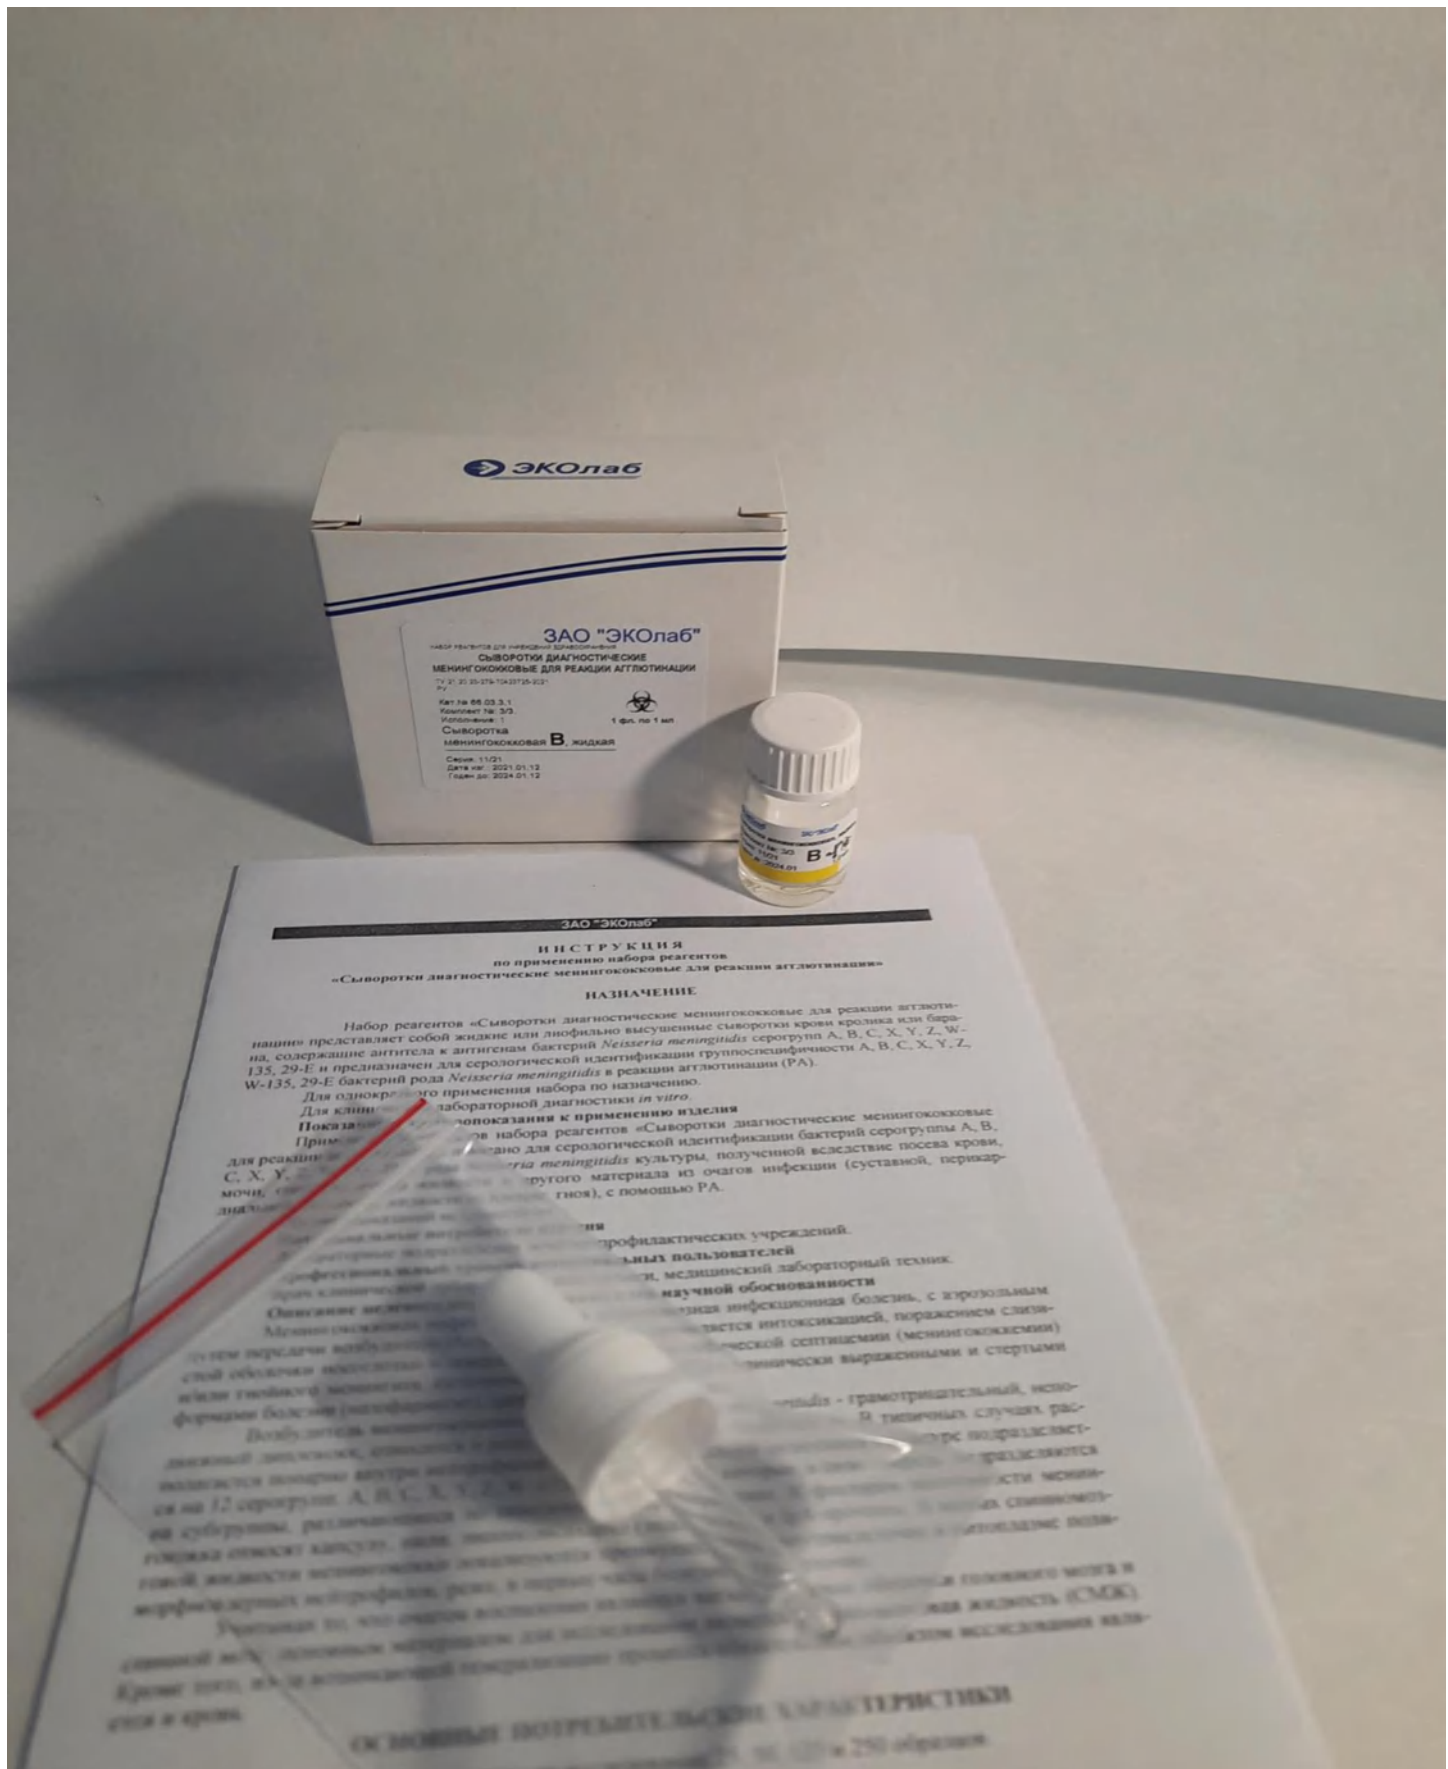

серия 12/21 от 2021.01.12



НАЗНАЧЕНИЕ

Для однократного применения набора по назначению
Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*

1997


[illegible]

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекты наборов рассчитаны на исследование 25, 50, 100 и 250 образцов.
Методы стерилизации изделий
 Изделие не требует стерилизации.
Программное обеспечение работы изделия
 Отсутствует.
Техническое обслуживание и ремонт изделия
 Изделие не требует технического обслуживания и не подлежит ремонту.

Комплект №4/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая С, сухая

серия 13/21 от 2021.01.12

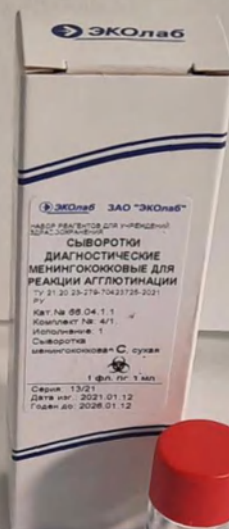

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.


Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая инвазивная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*. В типичных случаях располагается парно внутри нейтрофилов. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29Е, К, Н, L, I, которые, в свою очередь, подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К факторам патогенности менингококка относятся капсула, ферменты, белки, липиды и ДНК-материал. В менингококковой инфекции участвуют также другие микроорганизмы и факторы.

Комплект №4/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая С, сухая

серия 14/21 от 2021.01.12

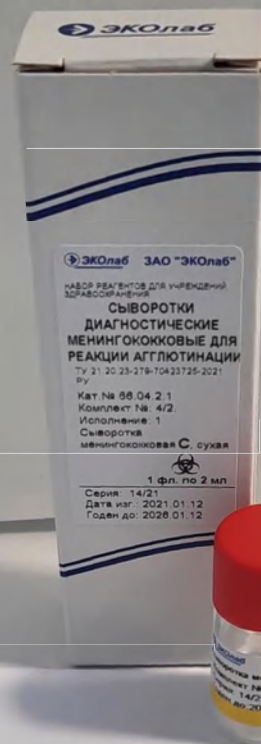

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначены для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.


Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая интродонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, дипло-

Комплект №4/3, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая С, жидкая

серия 15/21 от 2021.01.12

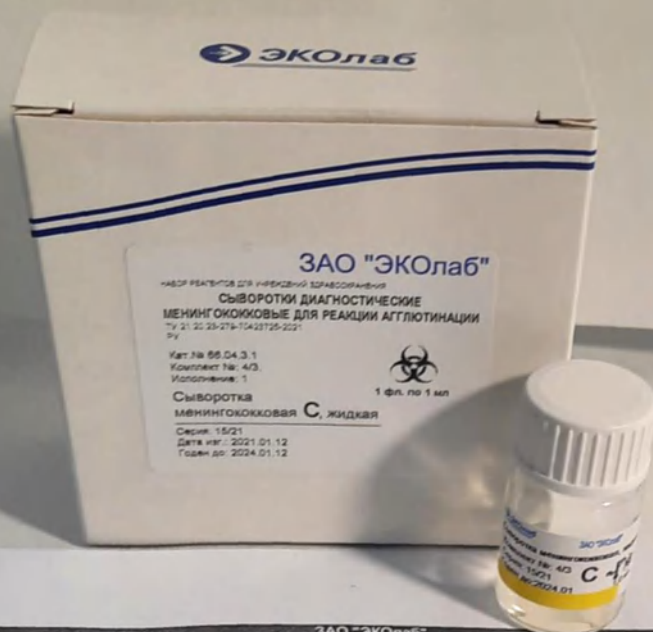

ЗАО "ЭКОлаб"
ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антигены к сывороткам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29-E и предназначены для биологической идентификации группоспецифичности А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29-E бактерий *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для определения группоспецифичности набора по назначению.

Для использования в лабораторной диагностике *in vitro*.

Показания к применению изделия

Применение набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые» для реакции агглютинации показано для биологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и других биологических жидкостей из пораженных органов и тканей.

Применение набора реагентов не предусмотрено.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Профессиональный уровень

Врач клинической лаборатории

Описание целевого анализа

Менингококковая инфекция - острая

пути передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*)

стой оболочки носоглотки и генерализацией в виде

жидкой гнойной менингита. Источником является

формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители

Возбудитель менингококковой инфекции - *Neisseria meningitidis*

двухвалентный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*

попадает внутрь нейтрофилов. Возбудитель по своей структуре делится

на 12 серогрупп: А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29-E, K, H, L, I, которые в свою очередь

на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К фактору

голова относится капсула, пили, липополисахарид (липопептид) и

тканевой жидкости менингококки локализуются преимущественно внутри

морфологических нейтрофилов, реже, в первые часы болезни - внеклеточ

Учитывая то, что очагом воспаления является мягкая мозговая оболочка головного мозга и

спинной жидкости, основным материалом для исследования является спинномозговая жидкость (СМЖ).

Кроме того, из-за возникающей генерализации процесса обследования проводят исследование


и крови.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

набор реагентов для идентификации 25, 50, 125 и 250 образцов


Комплект №4/4, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая С, жидкая

серия 16/21 от 2021.01.12

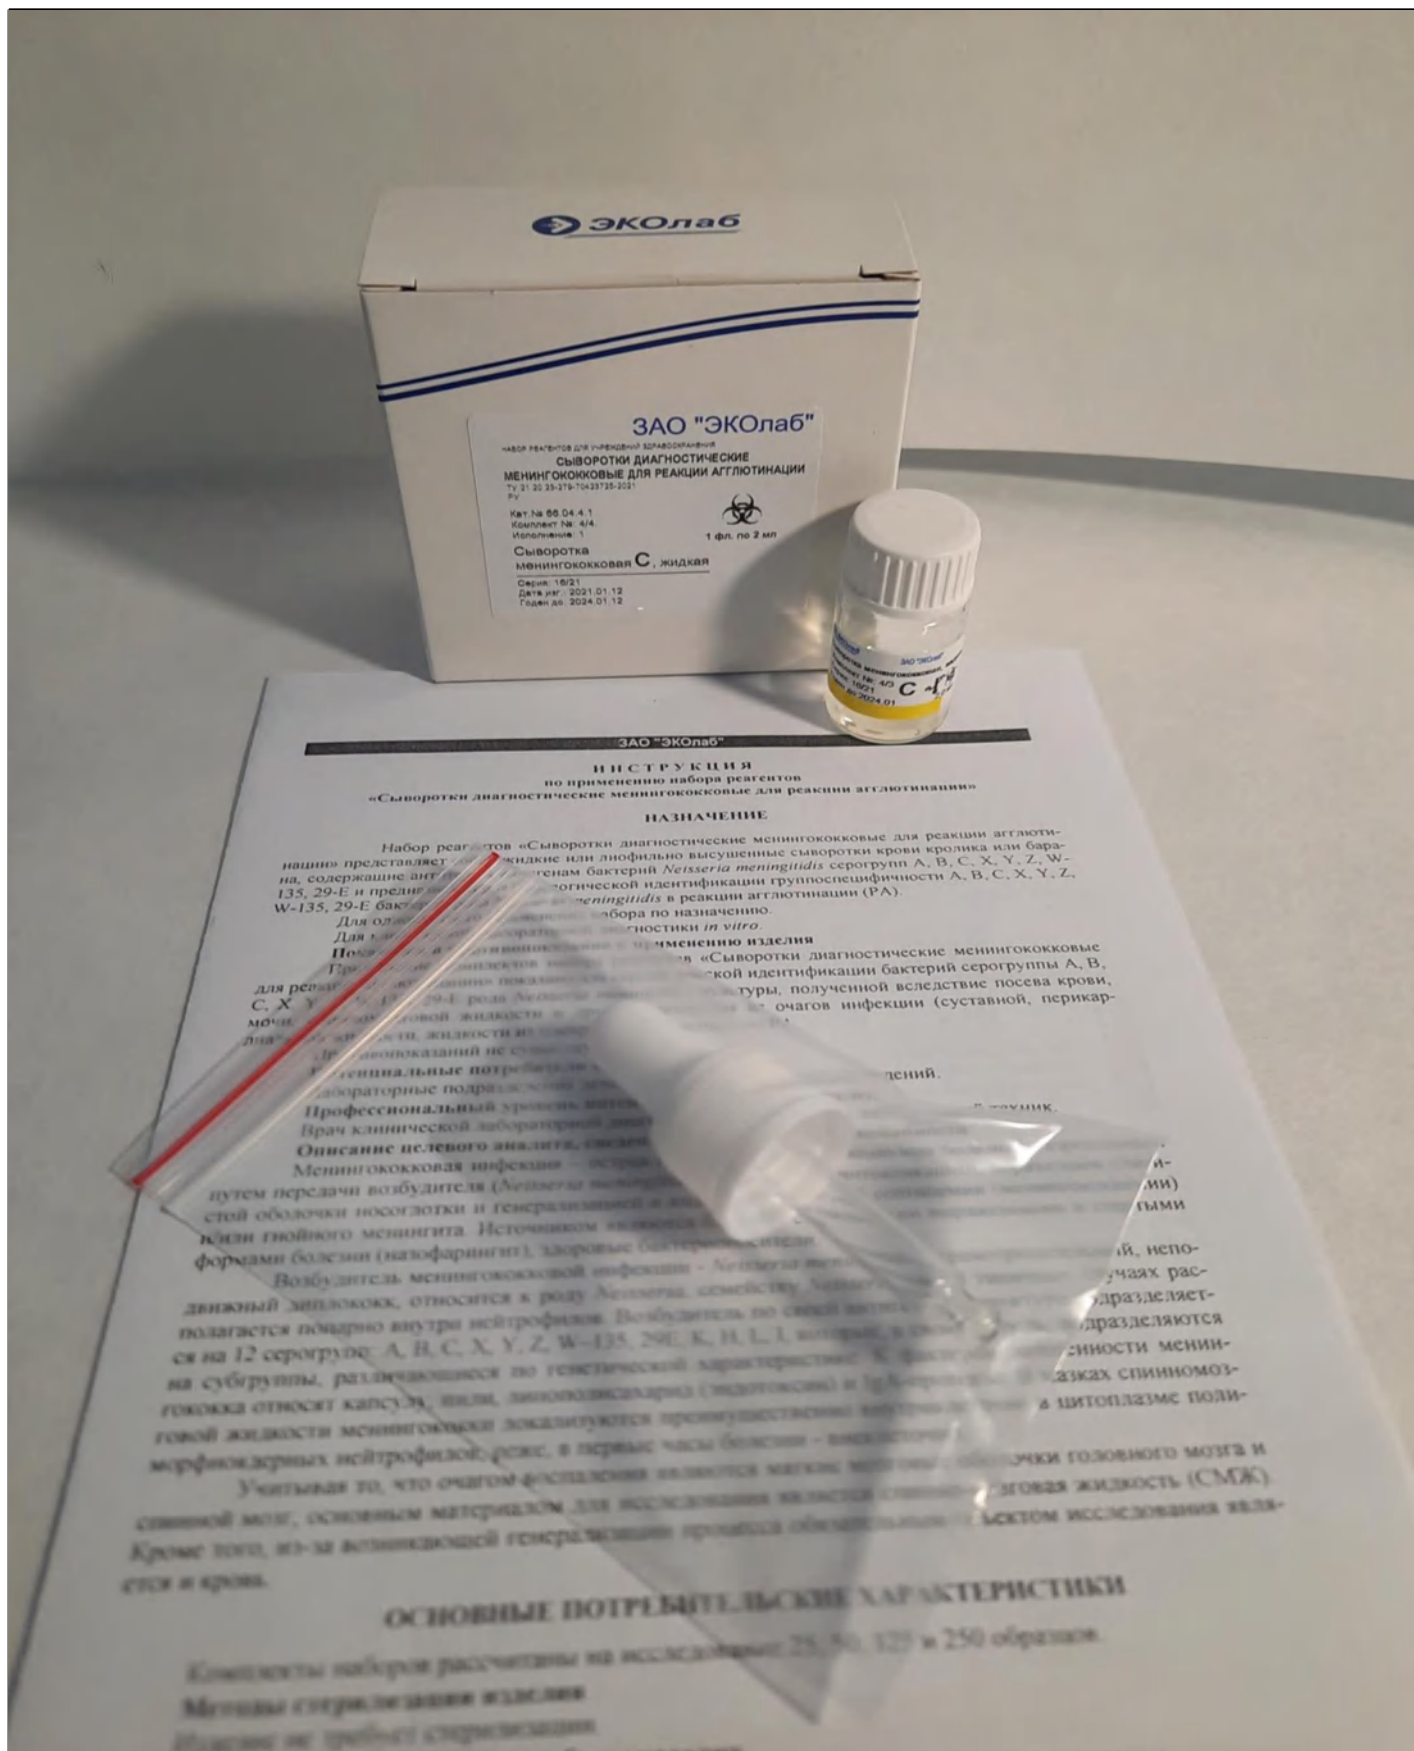


Комплект №5/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая X, сухая

серия 17/21 от 2021.01.12

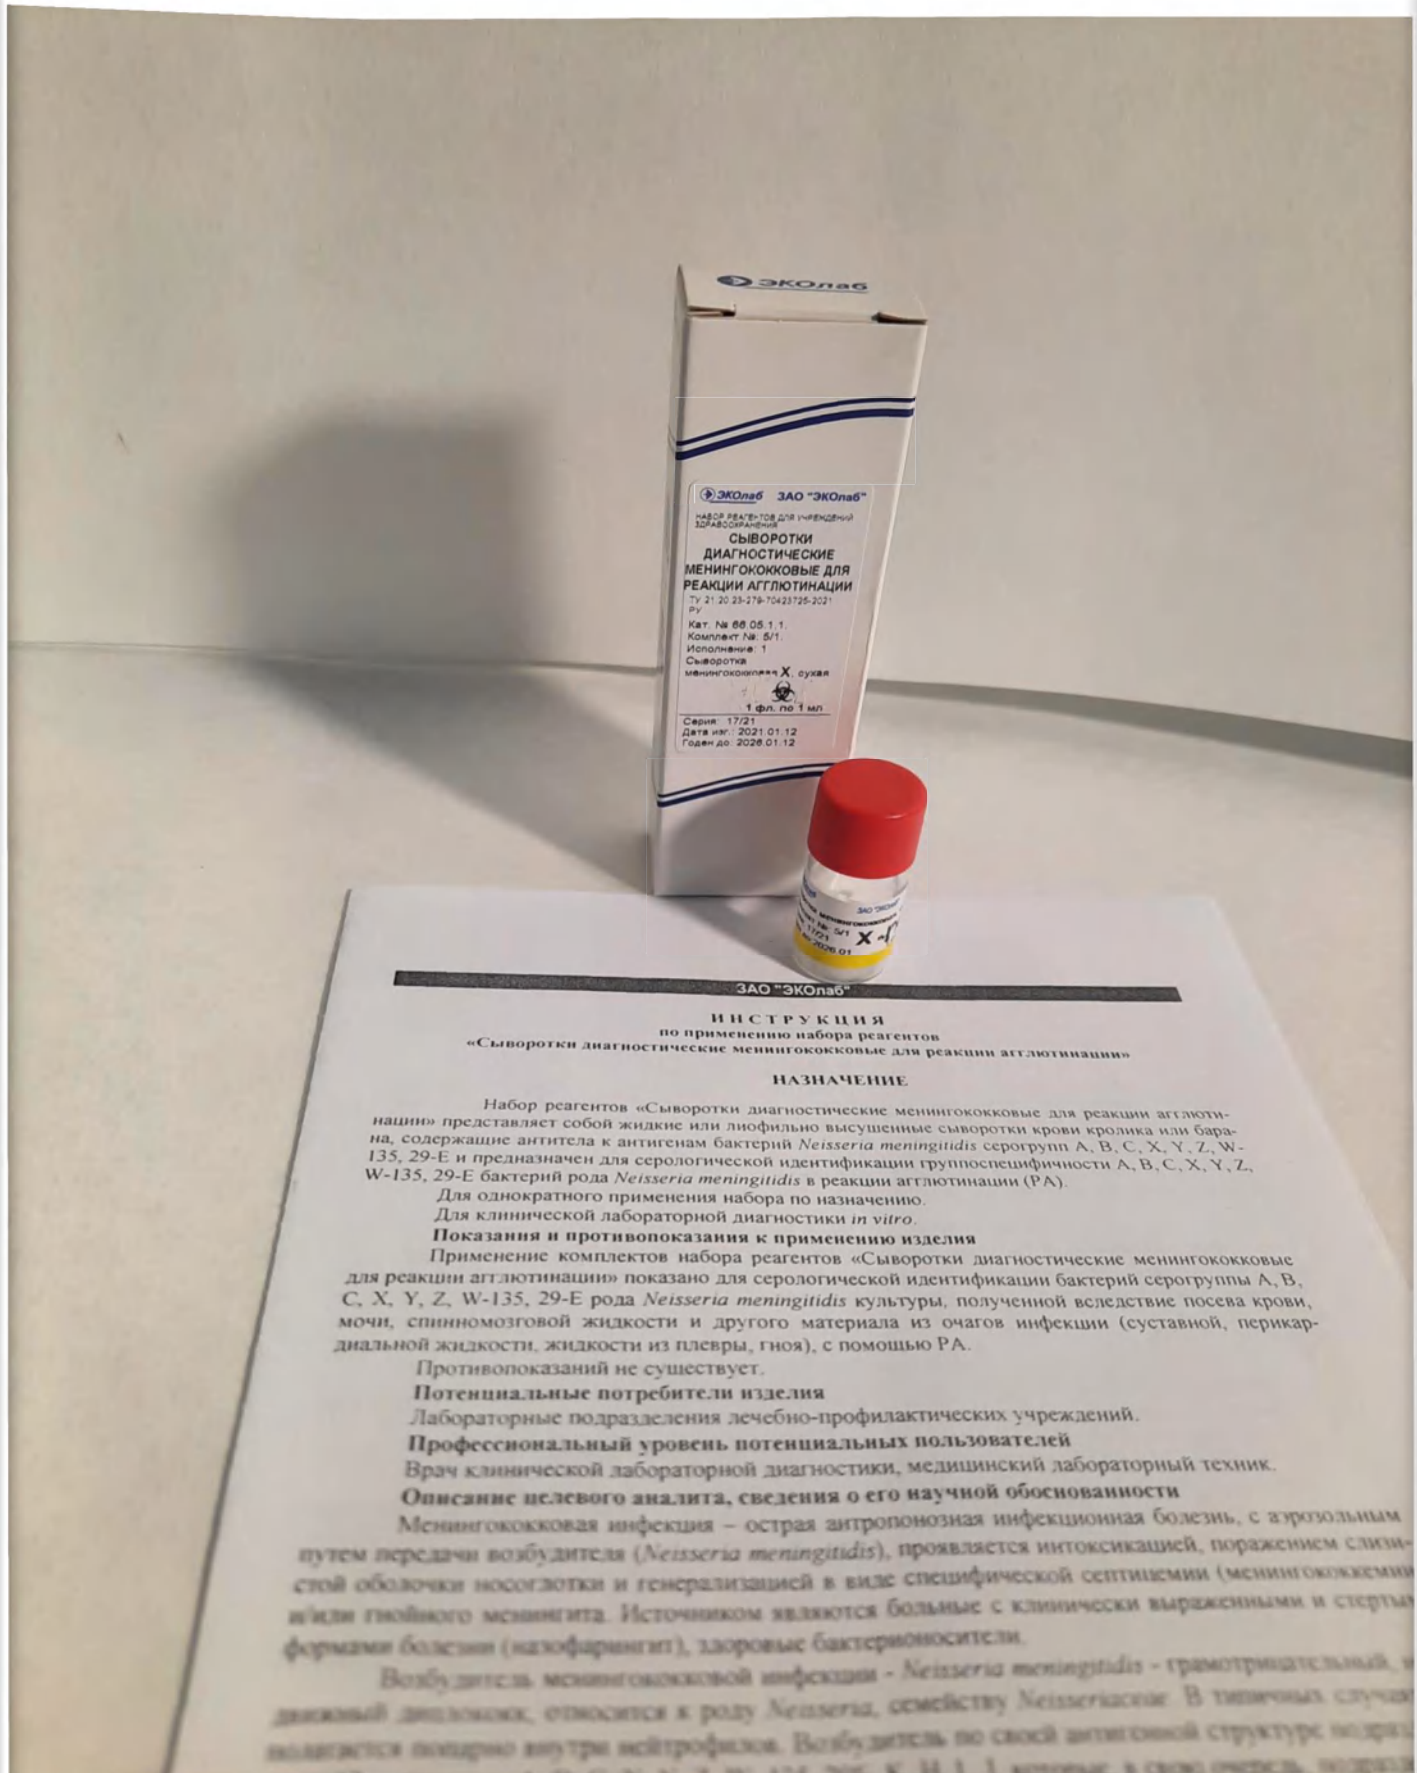


Комплект №5/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая X, сухая

серия 18/21 от 2021.01.12

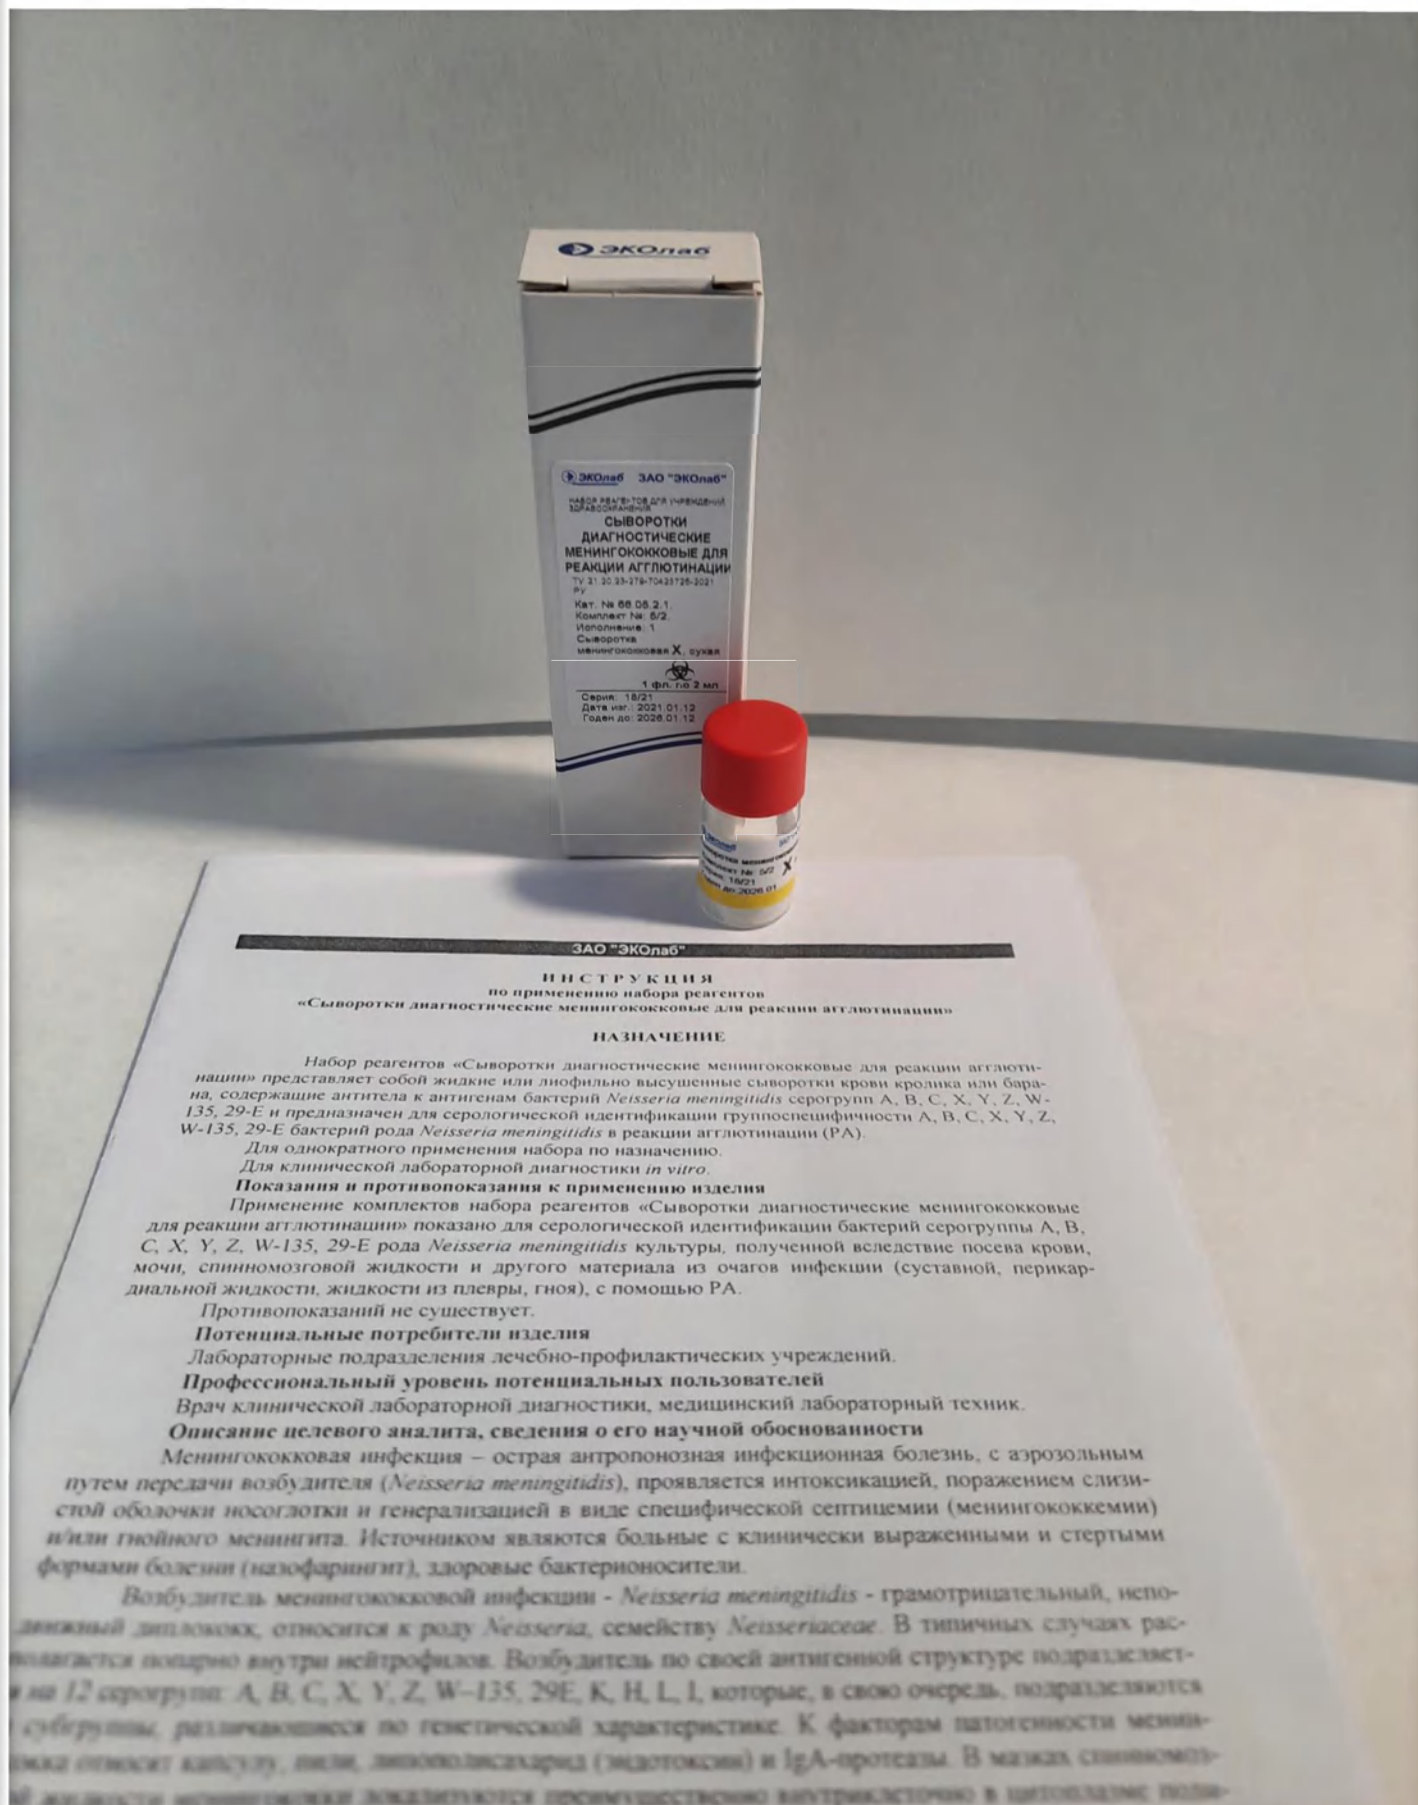


серия 19/21 от 2021.01.12

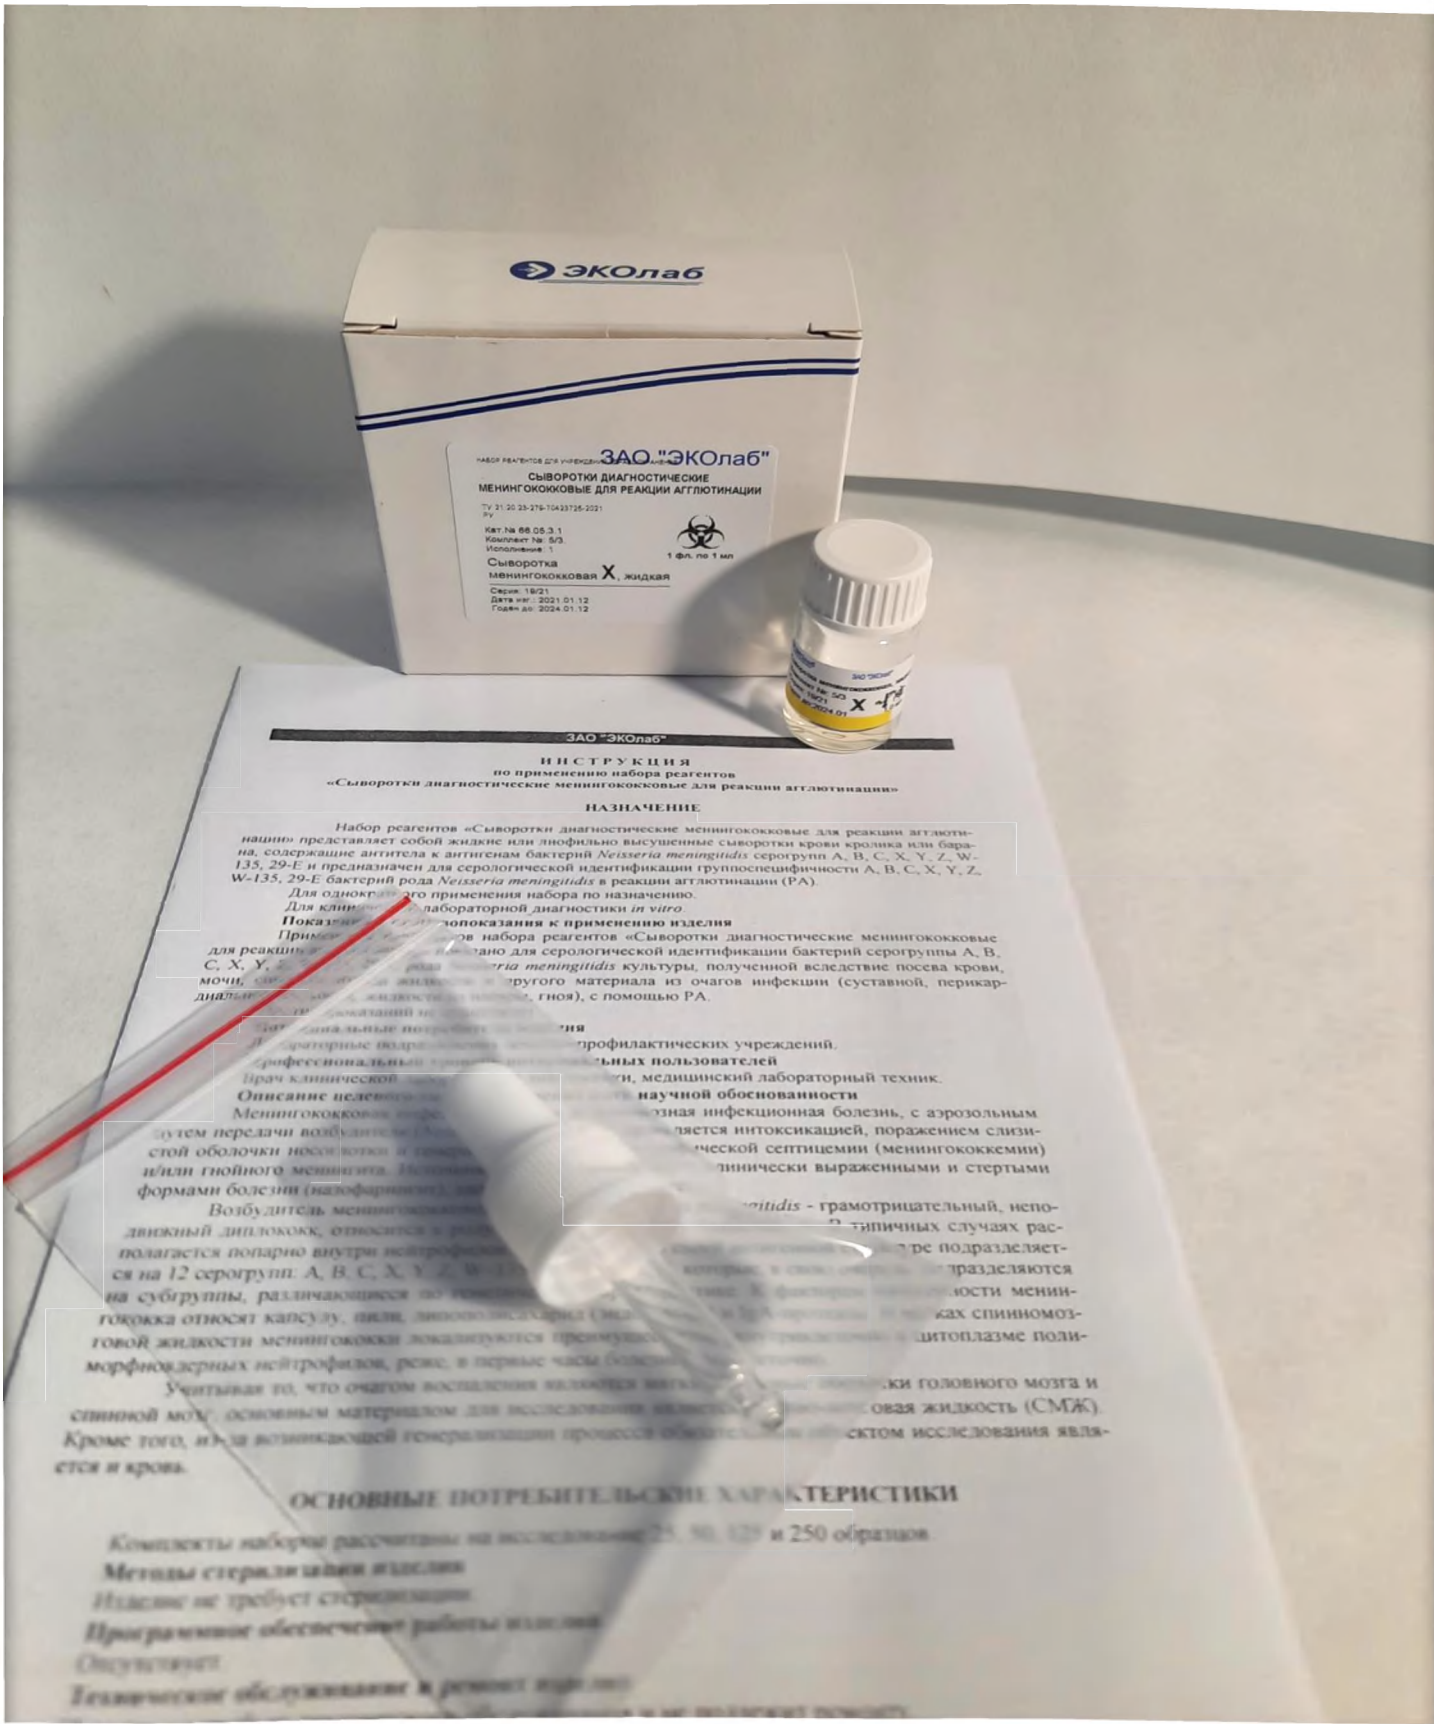


Комплект №5/4, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая X, жидкая

серия 20/21 от 2021.01.12

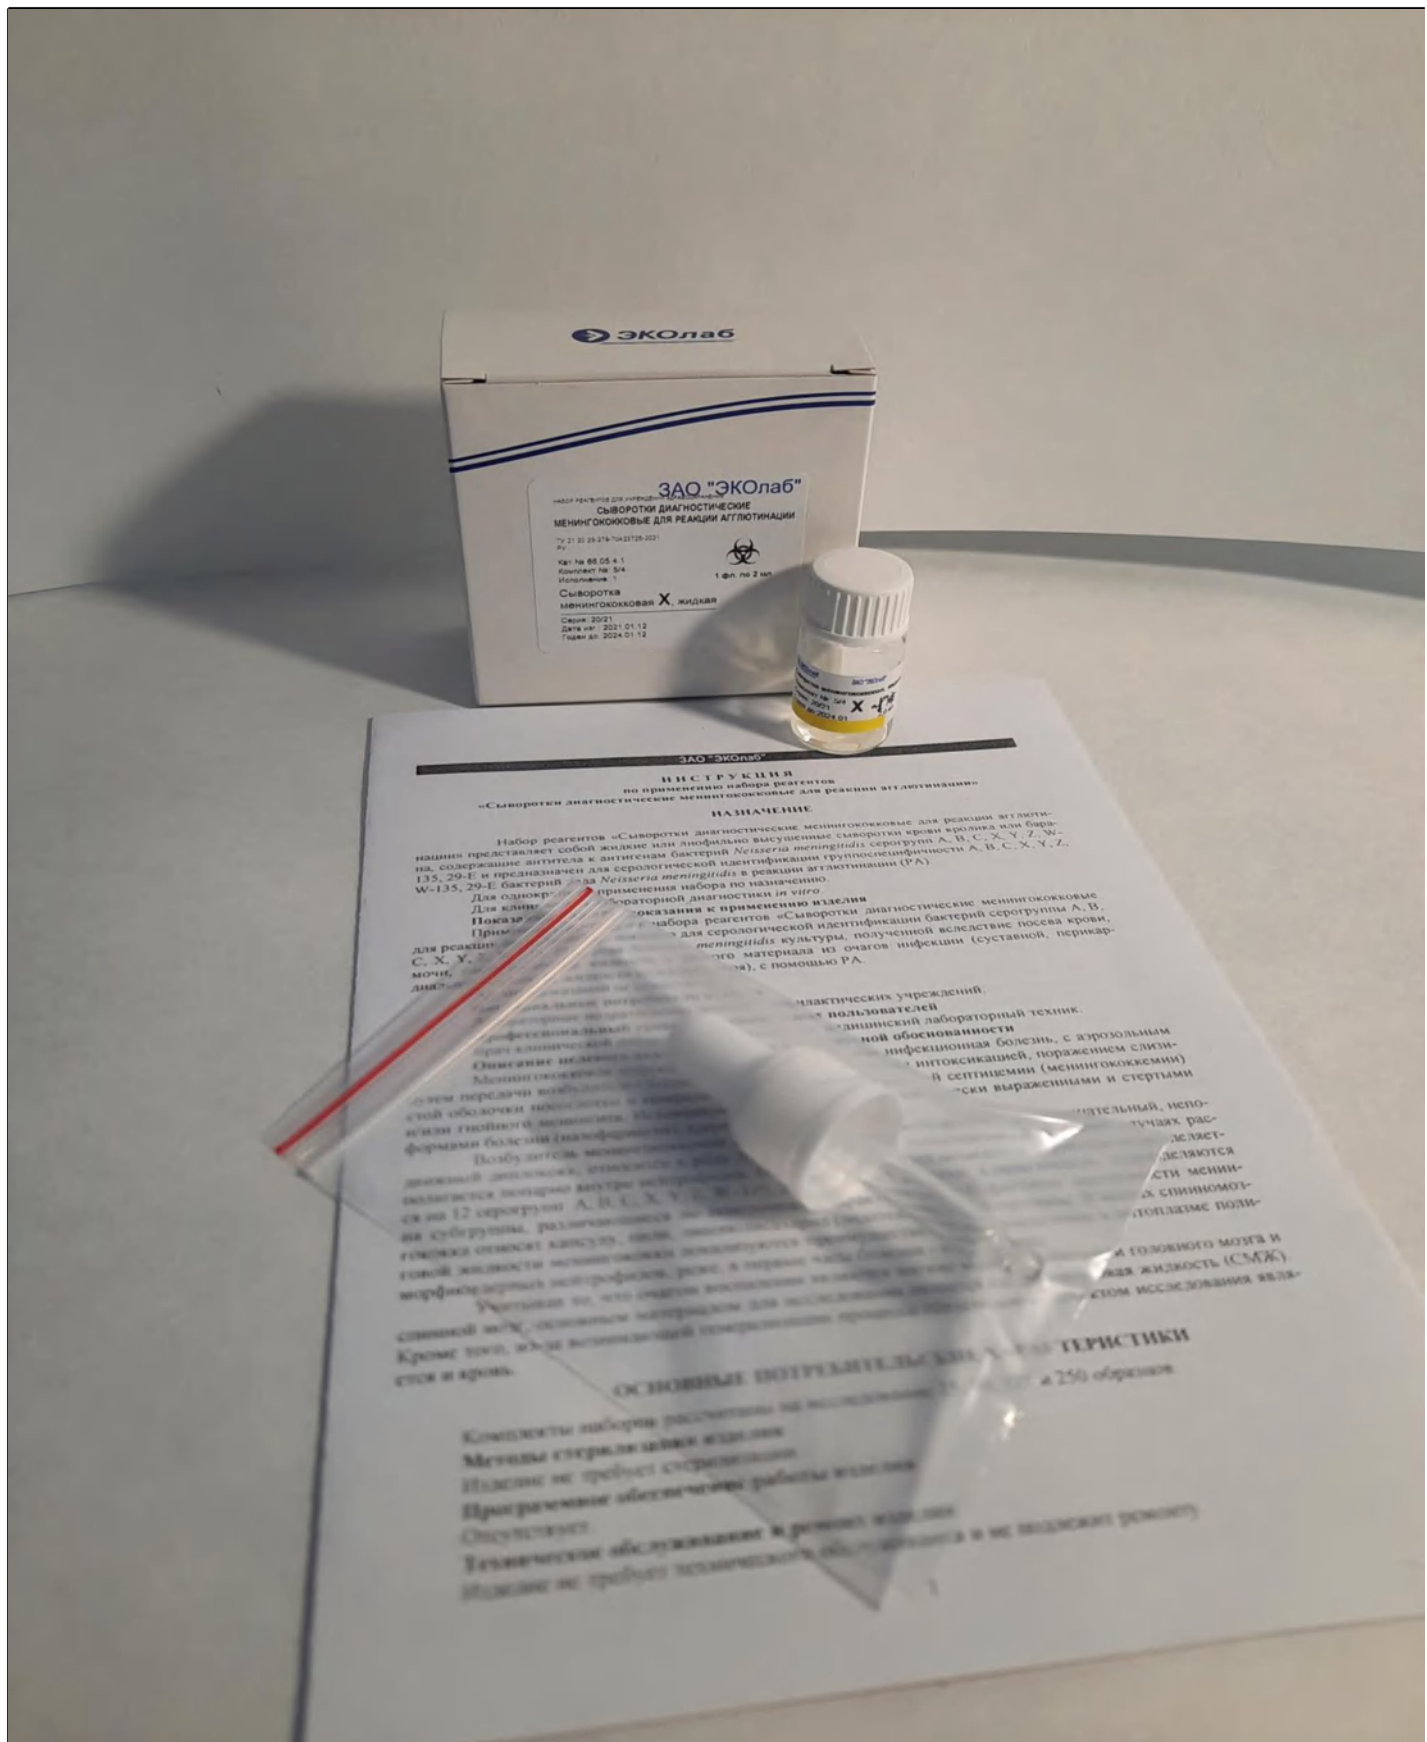

Комплект №6/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая Y, сухая

серия 21/21 от 2021.01.12

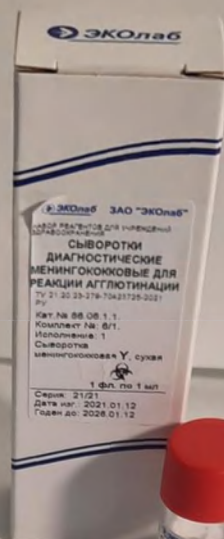

ЭКОлаб
ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофилизно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности


Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*. В типичных случаях располагается парно внутри нейтрофилов. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп: A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29E, K, H, L, I, которые, в свою очередь, подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К факторам патогенности менингококка относят капсулу, пили, липополисахарид (эндотоксин) и IgA-протеазы. В мазках спинномозговой жидкости менингококки локализуются преимущественно внутриклеточно в цитоплазме полиморфноядерных нейтрофилов, реже, в первые часы болезни – внеклеточно.

Учитывая то, что очагом воспаления являются мягкие мозговые оболочки головного мозга и спинной мозг, основным материалом для исследования является спинно-мозговая жидкость (СМЖ). Кроме того, из-за возникающей генерализации процесса обязательным объектом исследования явля-

Комплект №6/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая Y, сухая

серия 22/21 от 2021.01.12

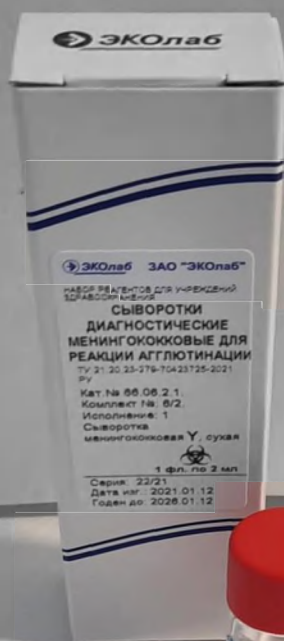

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая интродомозная инфекционная болезнь, с кроулольным нем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизи- в оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами менингококковой инфекции, носовые бактерионосители.

Комплект №6/3, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая Y, жидкая

серия 23/21 от 2021.01.12



ЭКОлаб

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической и лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания к применению изделия

Применяется для диагностики с помощью набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» в реакции агглютинации (РА) для серологической идентификации бактерий серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной, плевральной, костной, гной), с помощью РА.

Применение набора реагентов не требует специальных условий хранения.

Для лабораторных подразделений инфекционных, профилактических учреждений.

Профессиональная группа пользователей: врачи, медицинские лабораторный техник.

Описание целевого назначения изделия

Менингококковая инфекция – острая инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя, вызываемая бактерией *Neisseria meningitidis*, возбудитель которой имеет толстую оболочку носо-глоточной и генерализованной формы. Источником инфекции являются больные менингококковой инфекцией, а также носители менингококка в носоглоточной полости.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*. В зависимости от строения капсулы различают 12 серогрупп: A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E, которые в свою очередь подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетическим признакам. К факторам патогенности менингококка относят капсулу, пили, липополисахарид (липополисахарид), ферменты, белки, а также IgA-протеазы. В спинномозговой жидкости менингококки локализуются преимущественно в нейтрофильном и моноцитарном секторе.

Учитывая то, что очагом воспаления являются менингококки, возбудители менингита и головного мозга и спинной мозг, основным материалом для исследования является спинномозговая жидкость (СМЖ). Кроме того, из-за возникающей генерализации процесса обязательным объектом исследования является и кровь.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекты наборов рассчитаны на исследование 25, 50, 125 и 250 образцов.

Методы стерилизации изделия

Изделие не требует стерилизации.


Программное обеспечение работы изделия

Отсутствует.

Техническое обслуживание и ремонт изделия

Изделие не требует технического обслуживания и не подлежит ремонту.

серия 24/21 от 2021.01.12

[illegible]

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекты наборов рассчитаны на использование 25, 50, 100 и 250 образцов

Методы стерилизации изделий

Издание не требует согласования.

Приспособление обеспечивает работу в режиме

CHRYSLER

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Комплект №7/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая Z, сухая

серия 25/21 от 2021.01.12



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначены для серологической идентификации группоспецифичности A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей


Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми


Комплект №7/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая Z, сухая

серия 26/21 от 2021.01.12

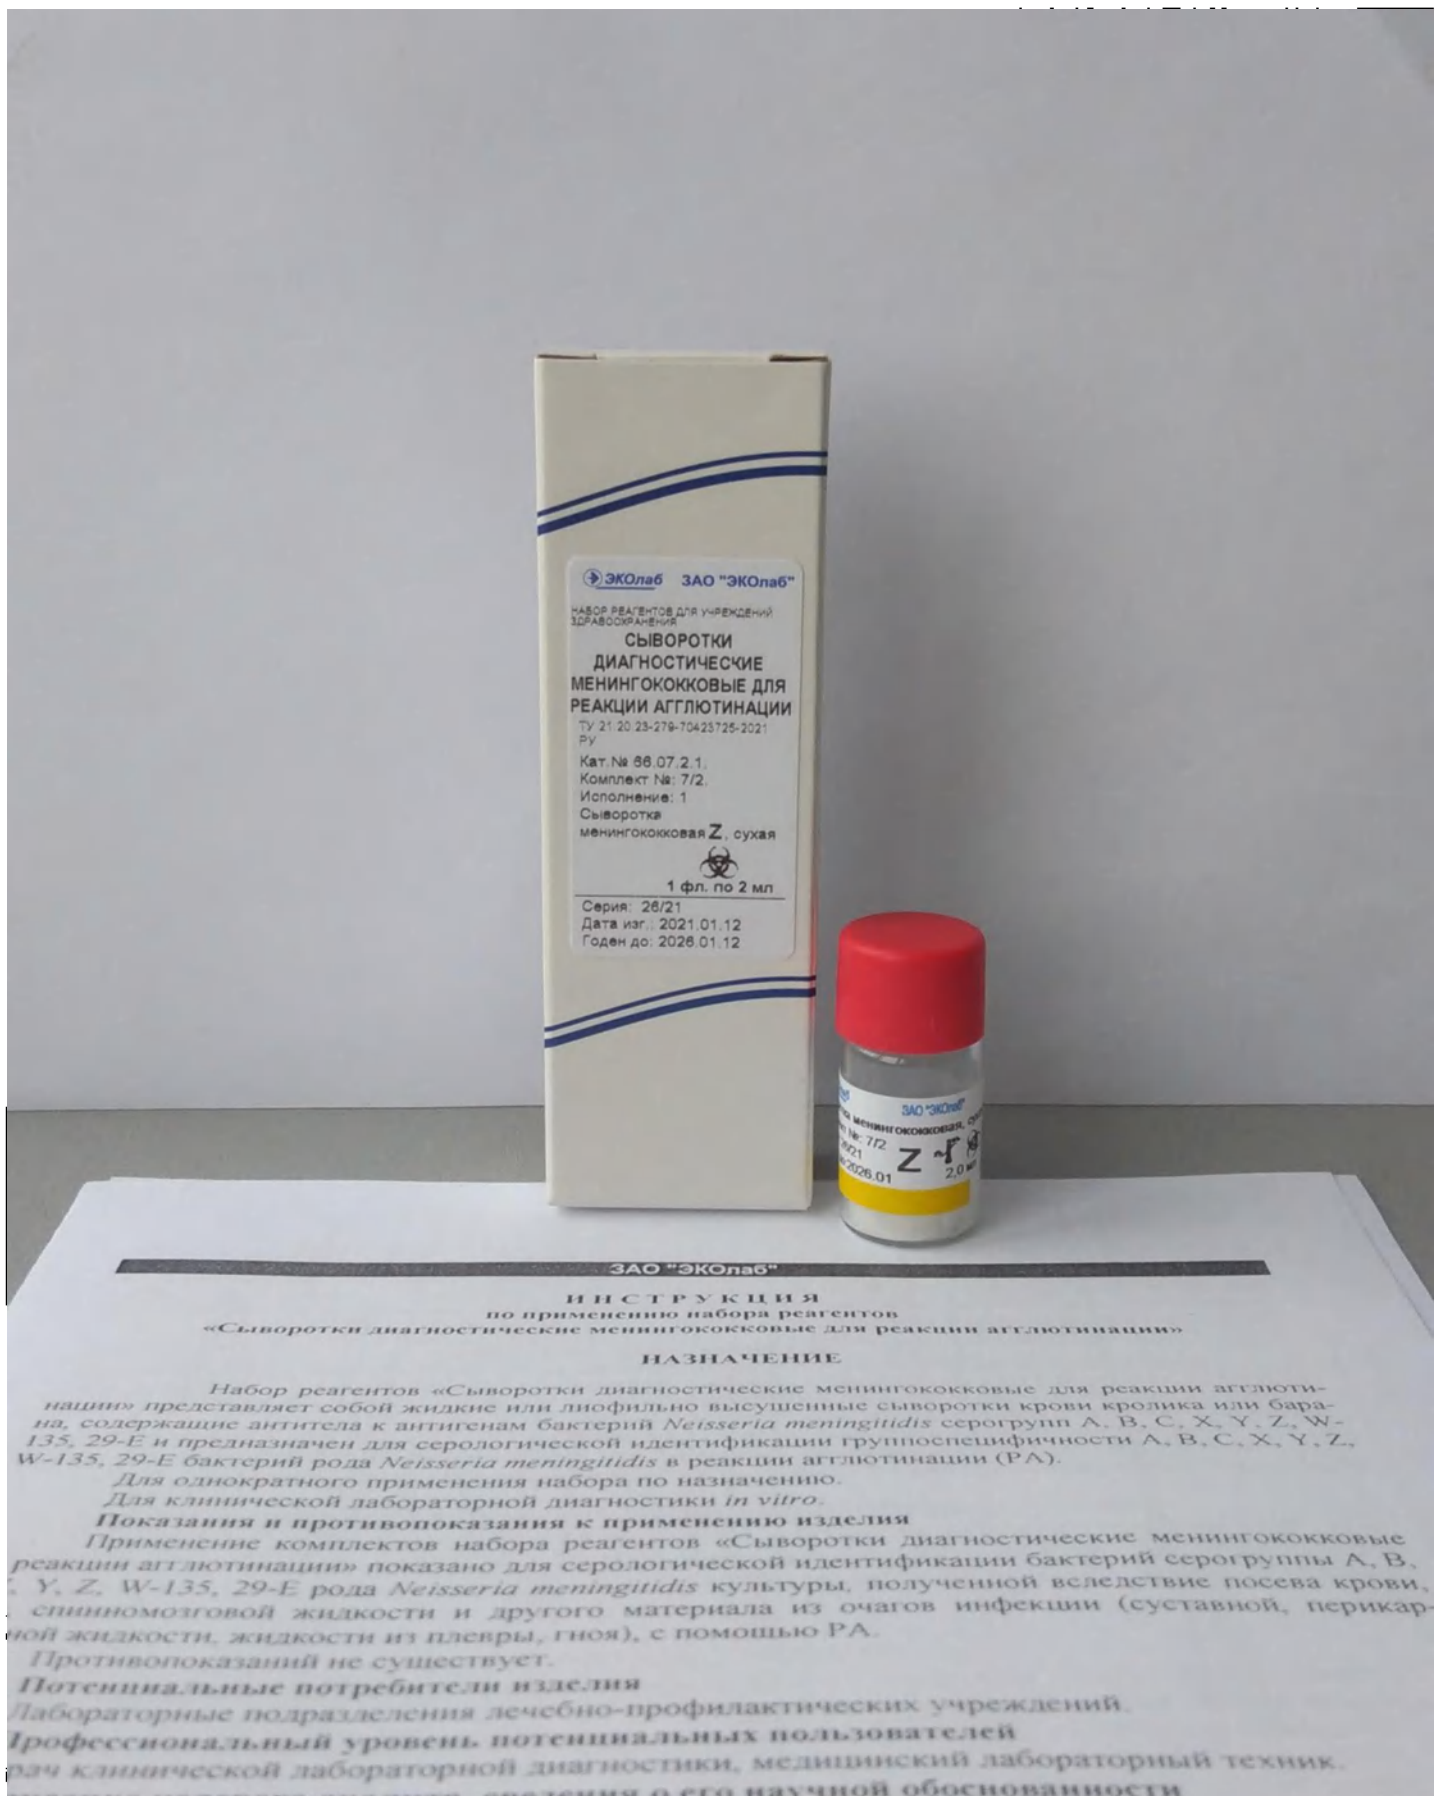

Комплект №7/4, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая Z, жидкая

серия 28/21 от 2021.01.12

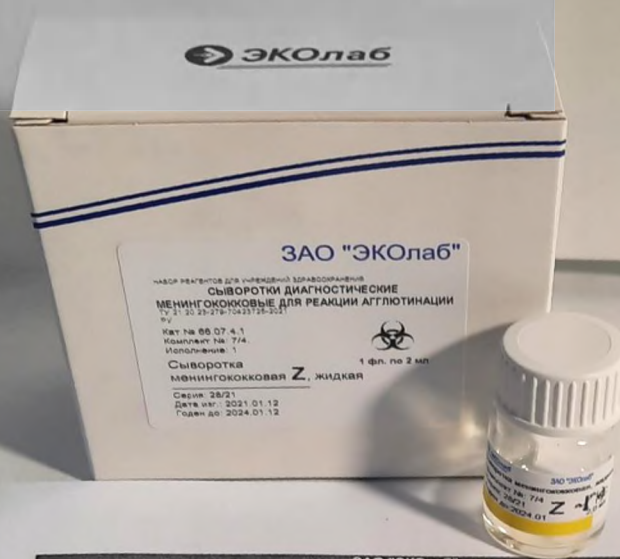

ЗАО "ЭКОлаб"
ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания к применению набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

Применяется для диагностики серогруппы *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости, другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной, плевральной, синовиальной, гноя), с помощью РА.

Противопоказания к применению изделия

Отсутствуют.

Описание целевого назначения

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция


Менингококковая инфекция

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекты набора рассчитаны на исследование 25, 50, 125 и 250 образцов.


Комплект №8/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая W-135, сухая

серия 29/21 от 2021.01.12

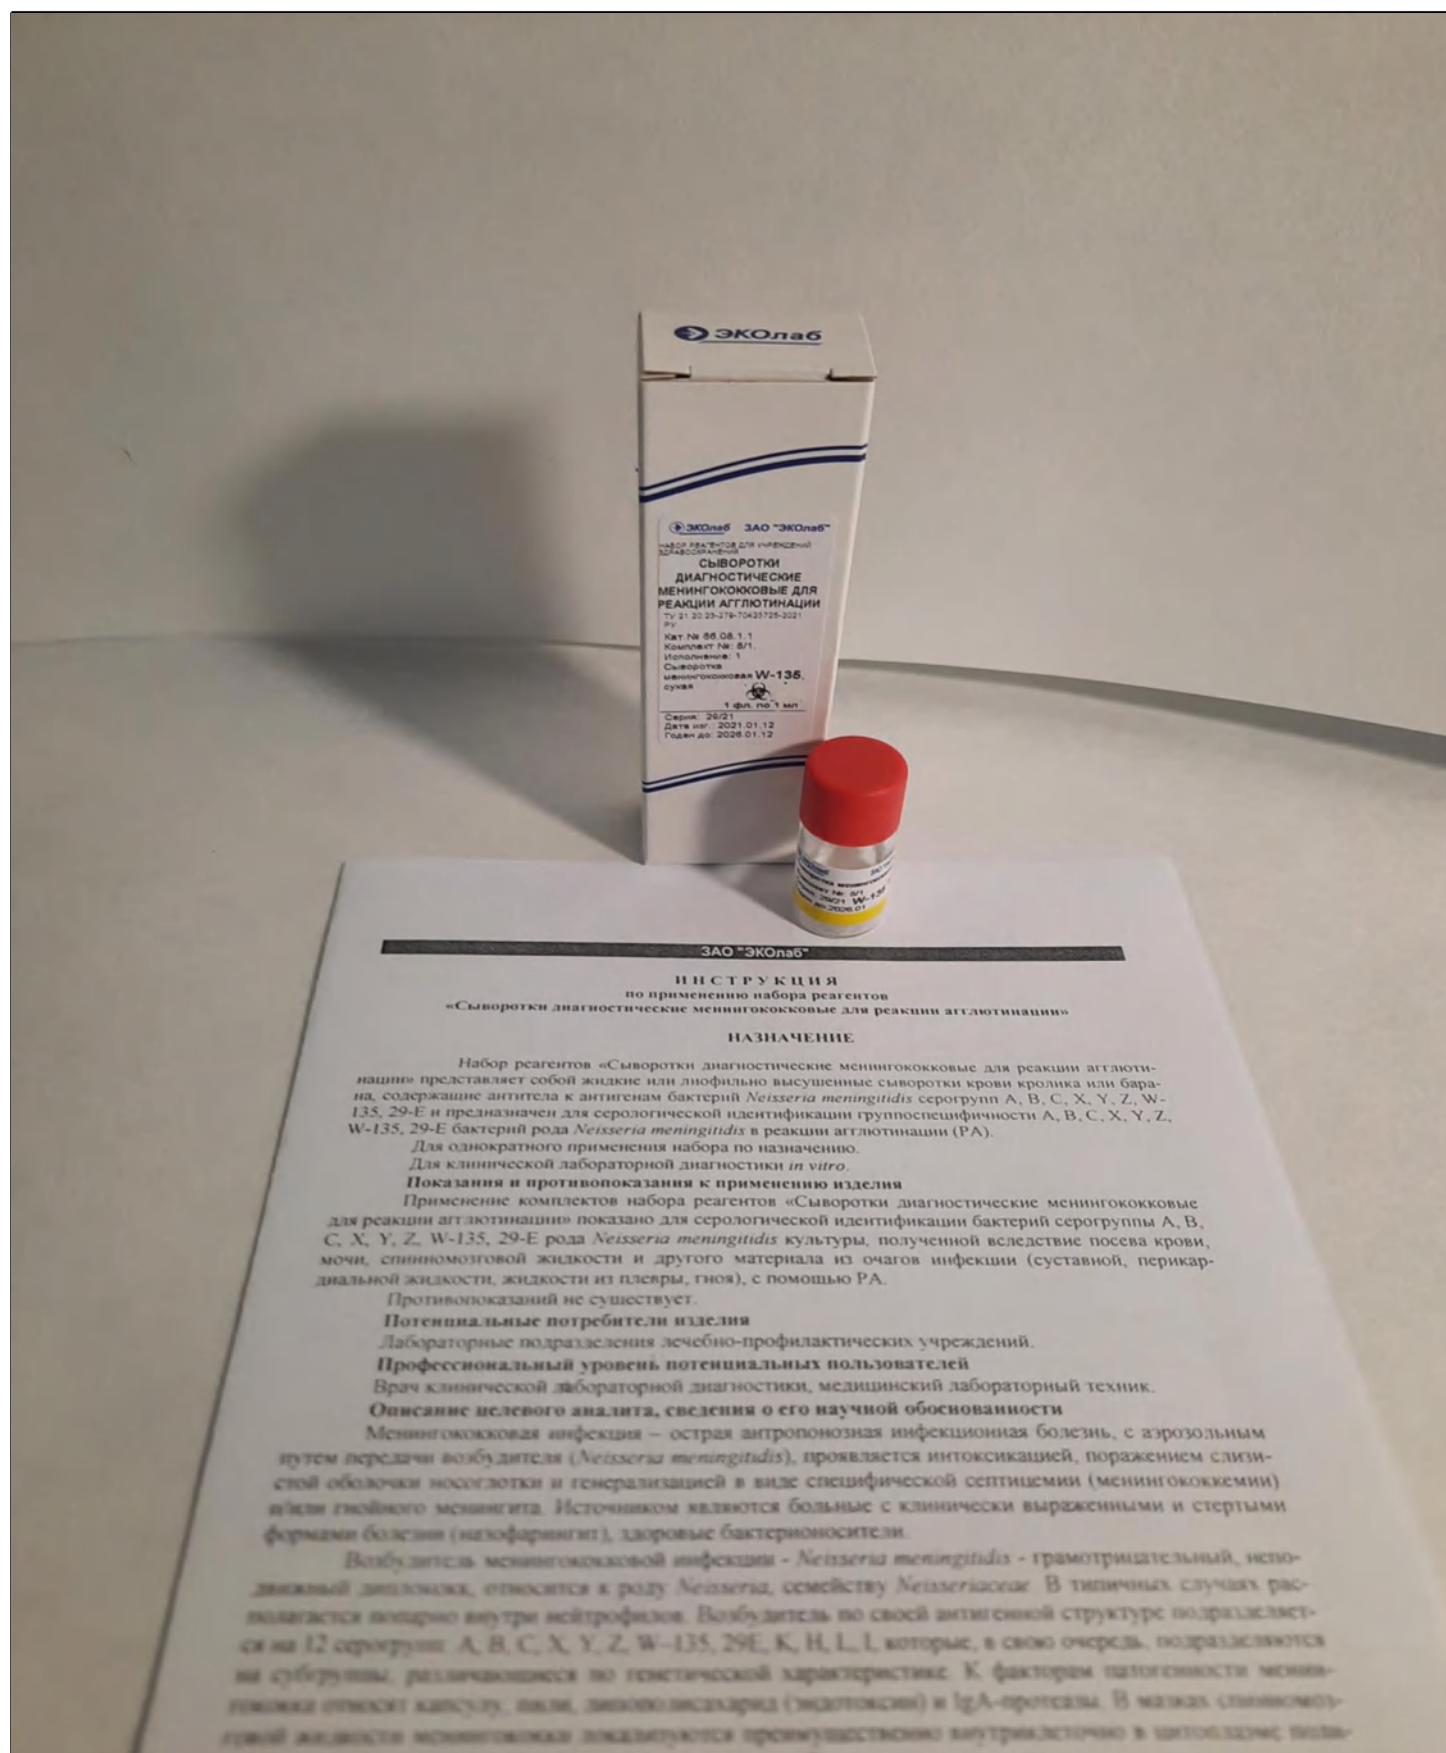

Комплект №8/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая W-135, сухая

серия 30/21 от 2021.01.12

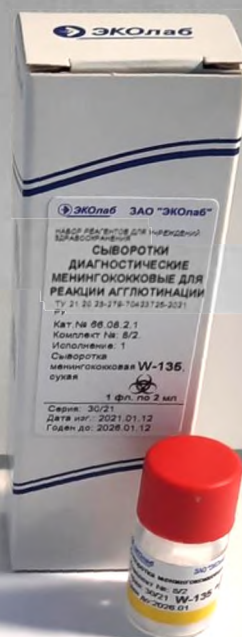

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.
Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности


Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*. В типичных случаях располагается парно внутри нейтрофилов. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29Е, К, Н, L, I, которые, в свою очередь, подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К факторам патогенности менингококка относят капсулу, пили, липополисахарид (эндоксин) и IgA-протеазы. В мазках спинномозговой жидкости менингококки локализуются преимущественно внутриклеточно в цитоплазме полиморфных нейтрофилов, реже, в первые часы болезни – внеклеточно.

Учитывая то, что очагом воспаления являются мягкие мозговые оболочки головного мозга и спинного мозга, основным материалом для исследования является спинно-мозговая жидкость (СМЖ).


Комплект №8/3, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая W-135, жидкая

серия 31/21 от 2021.01.12

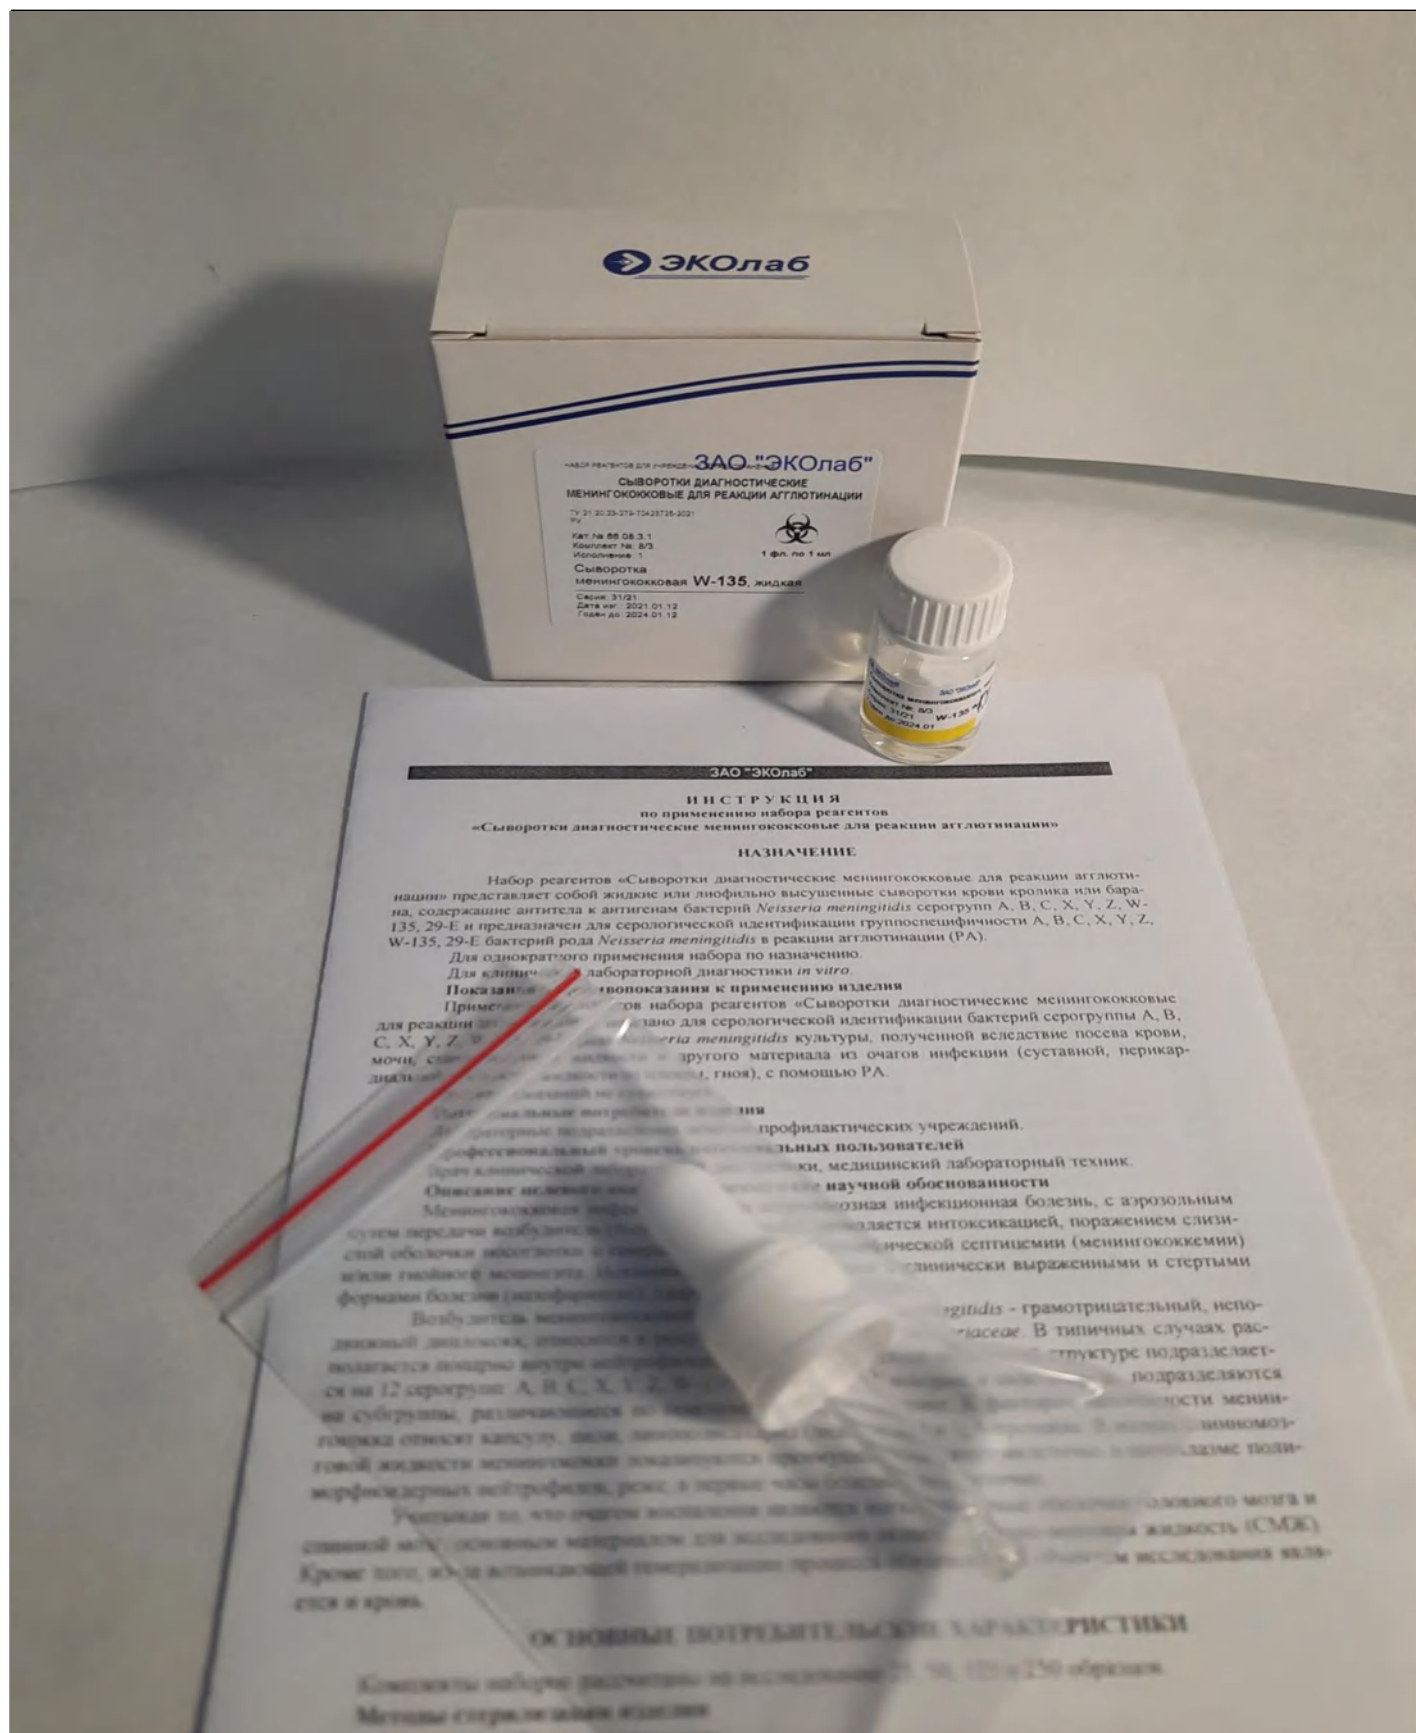


Комплект №8/4, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая W-135, жидкая

серия 32/21 от 2021.01.12

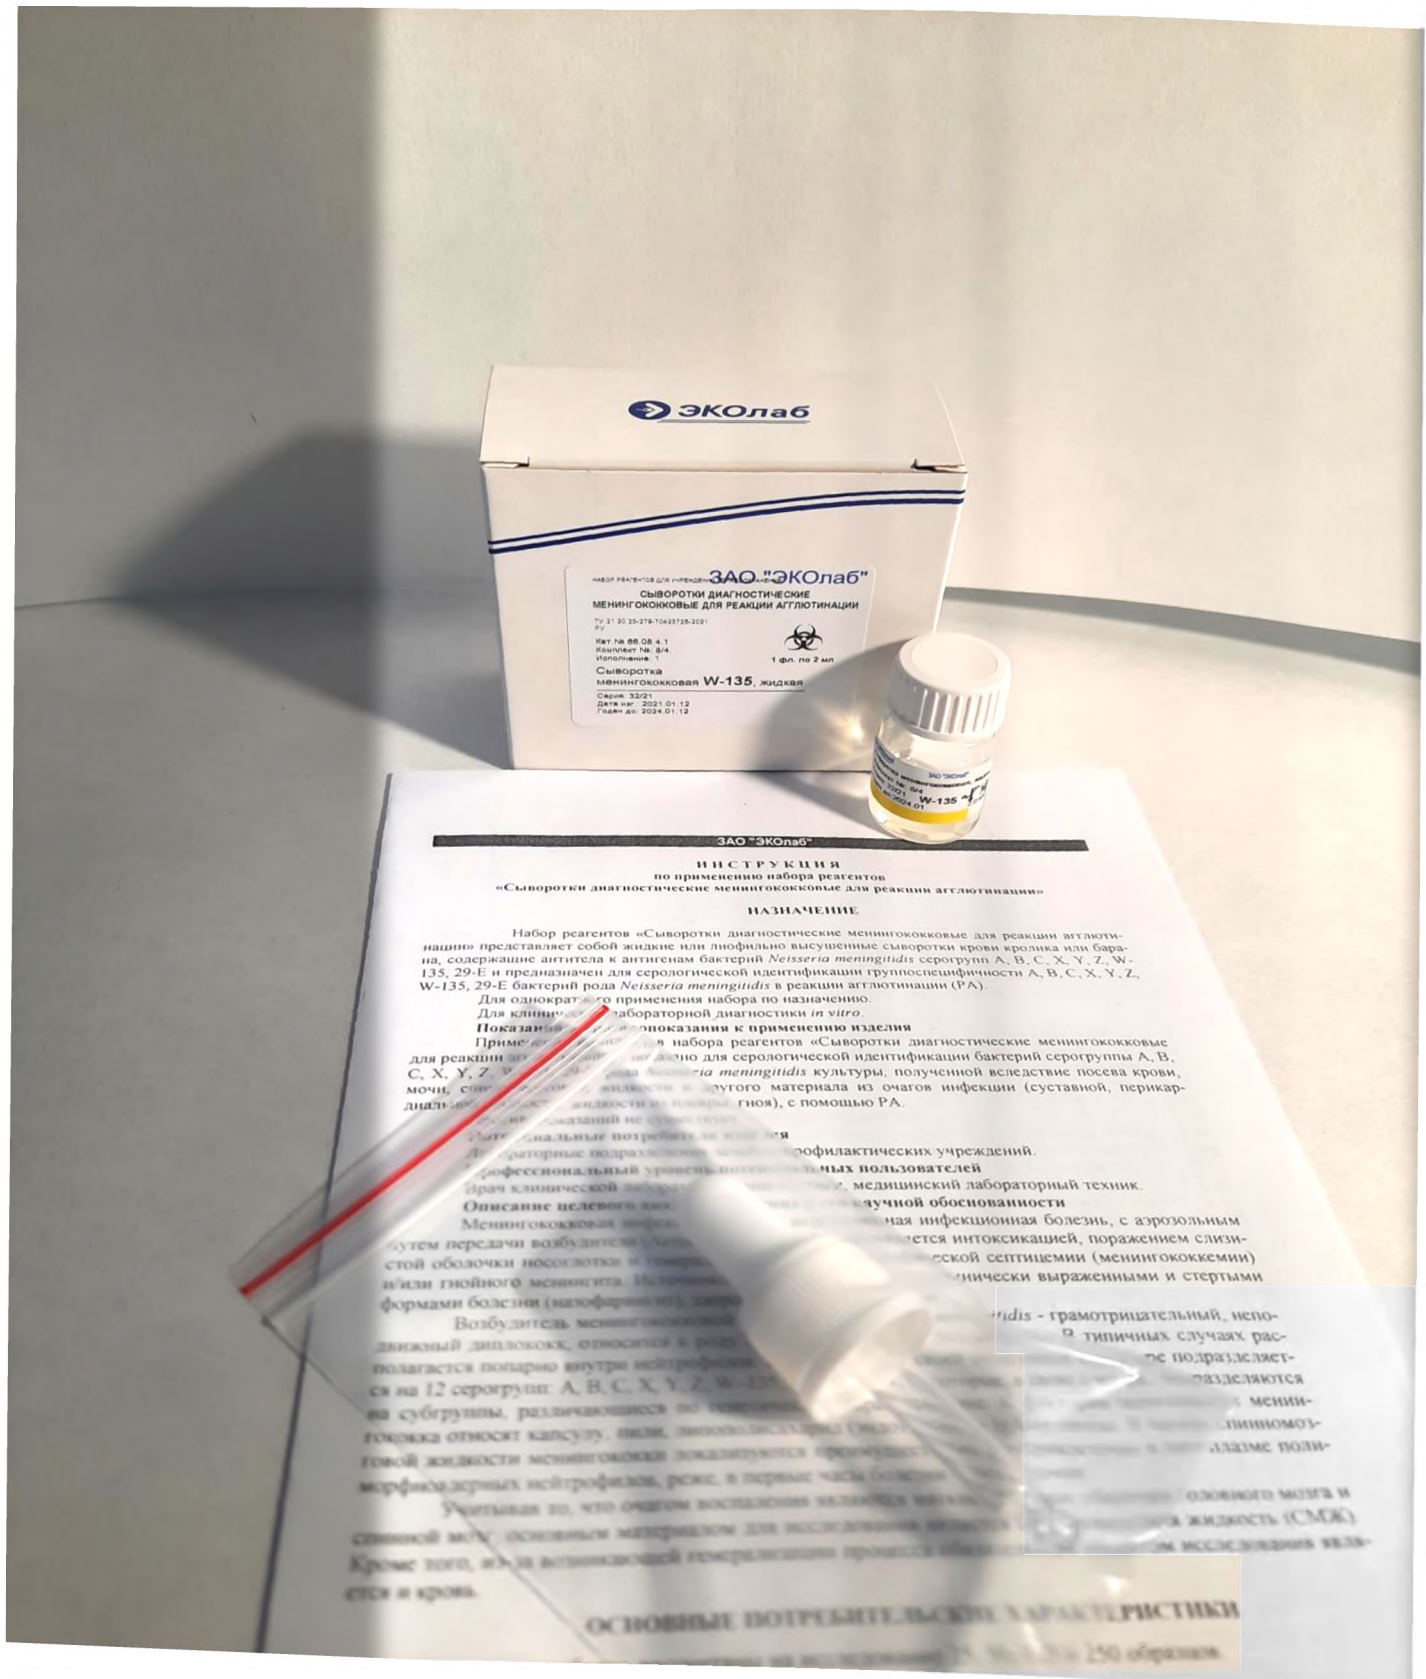


Комплект №9/1, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая 29-Е, сухая

серия 33/21 от 2021.01.12

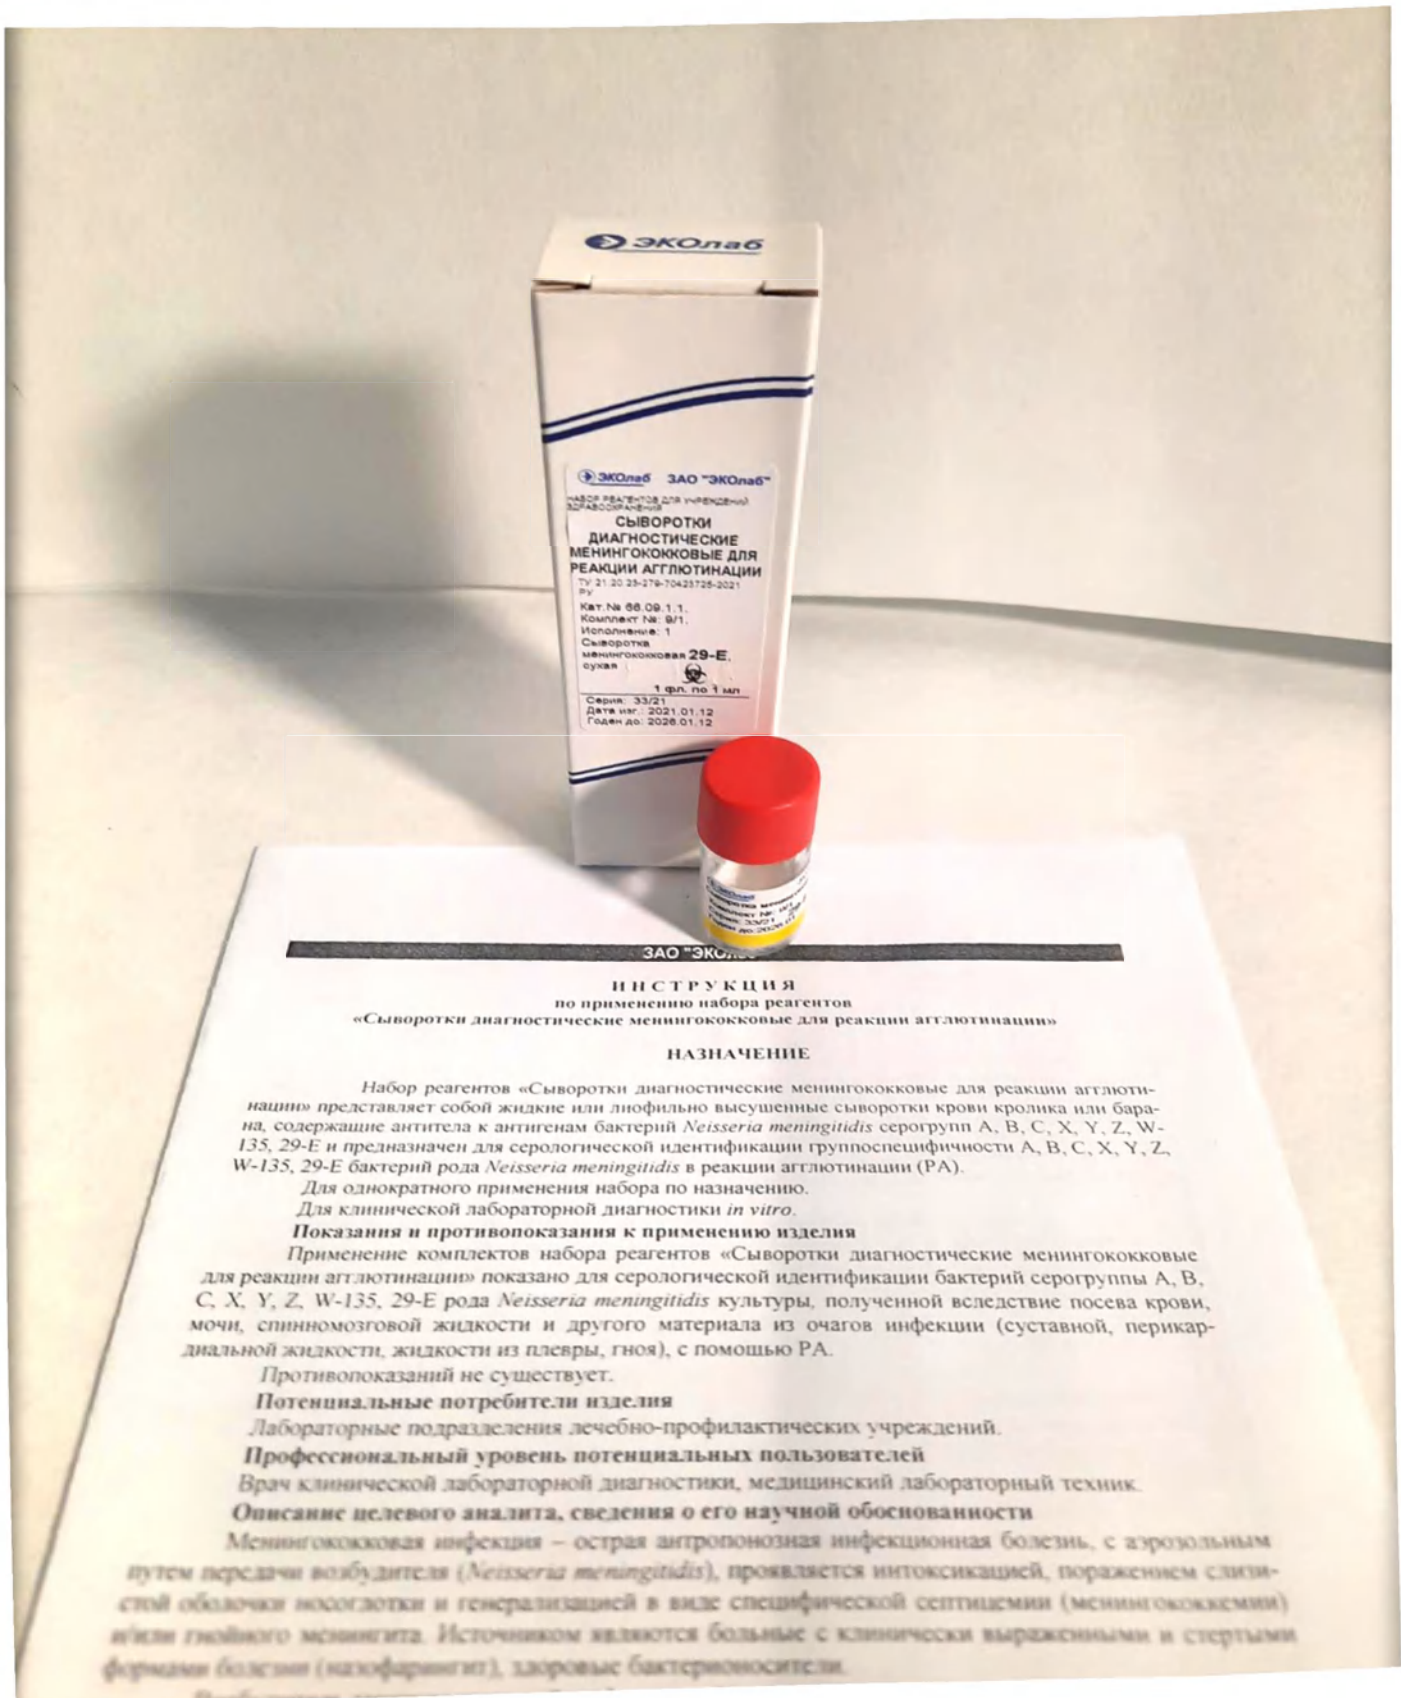

Комплект №9/2, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая 29-Е, сухая

серия 34/21 от 2021.01.12

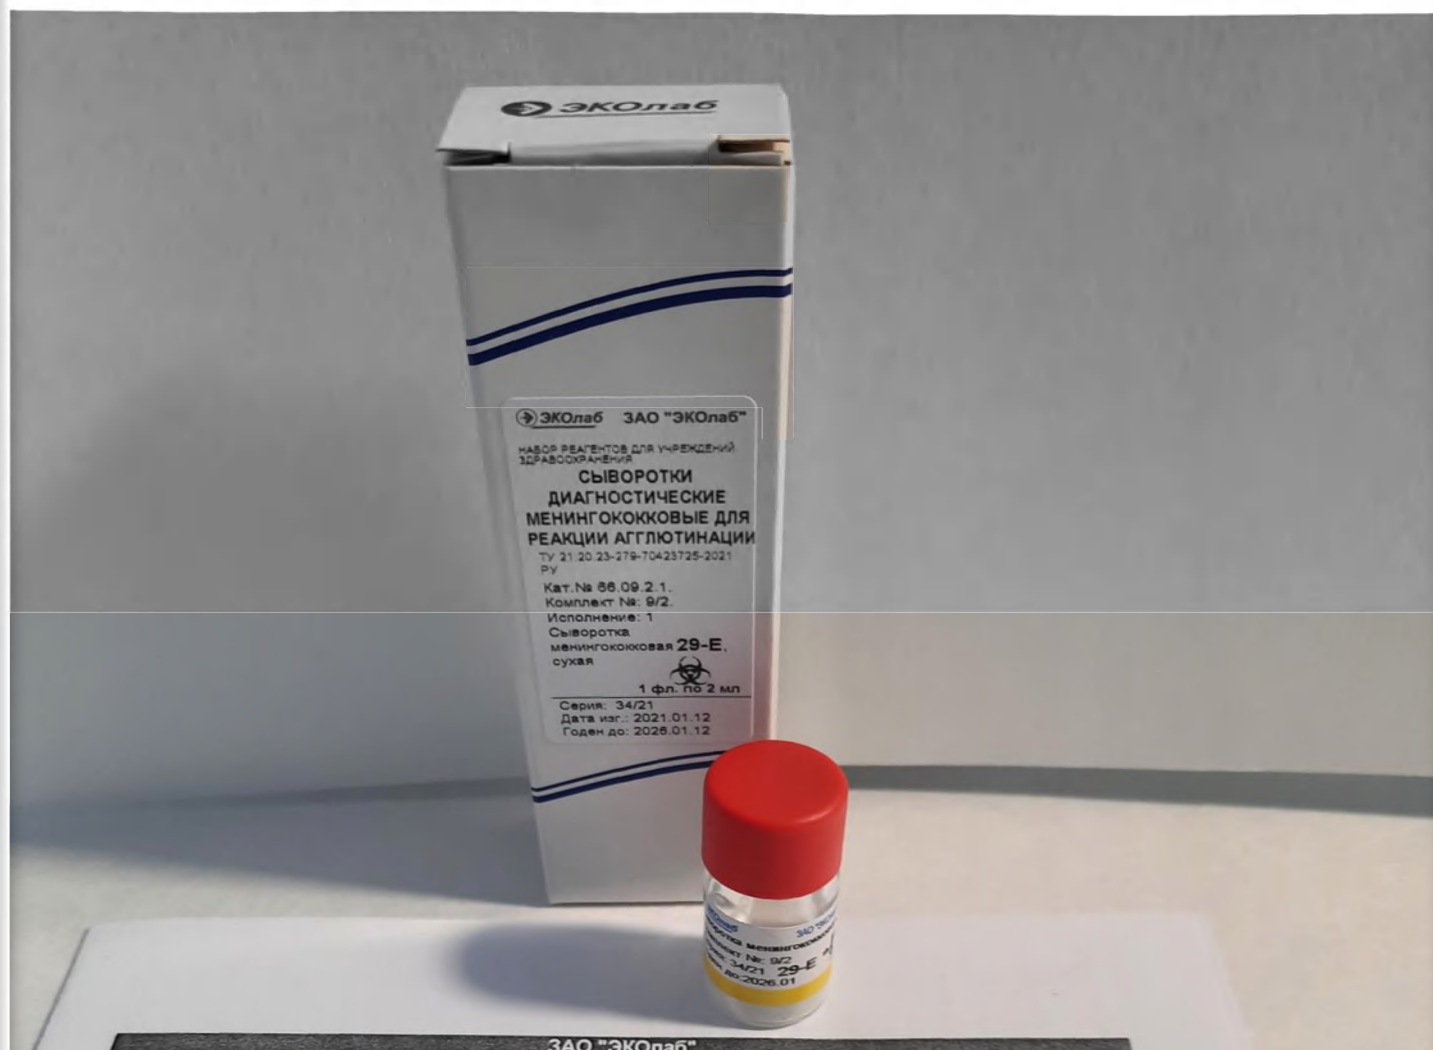

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы A, B, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия


лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

профессиональный уровень потенциальных пользователей

в клинической лабораторной диагностике, медицинский лабораторный техник.


Комплект №9/3, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая 29-Е, жидкая

серия 35/21 от 2021.01.12

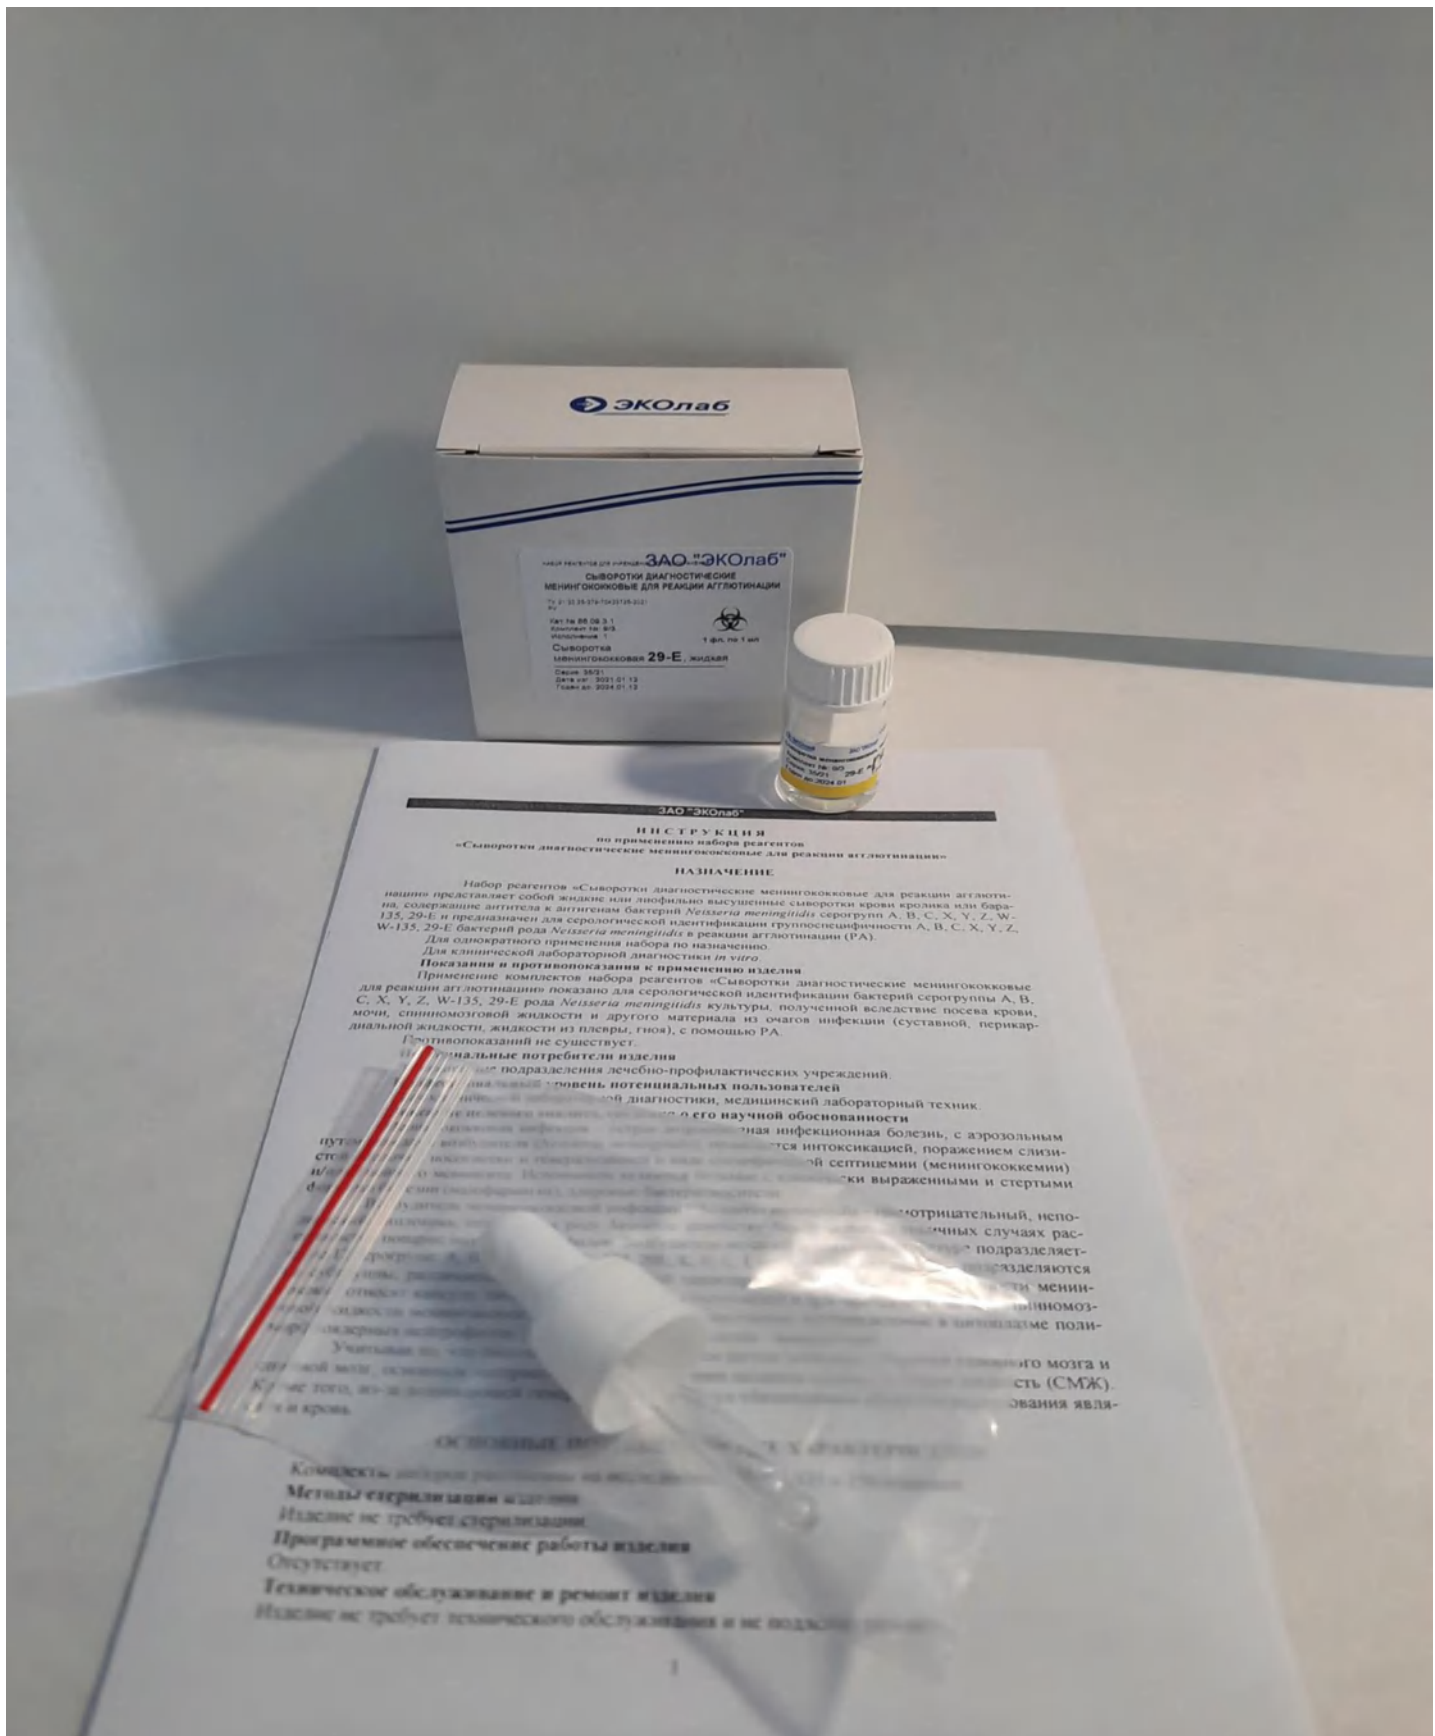


Комплект №9/4, Исполнение 1
Сыворотка менингококковая 29-Е, жидкая

серия 36/21 от 2021.01.12

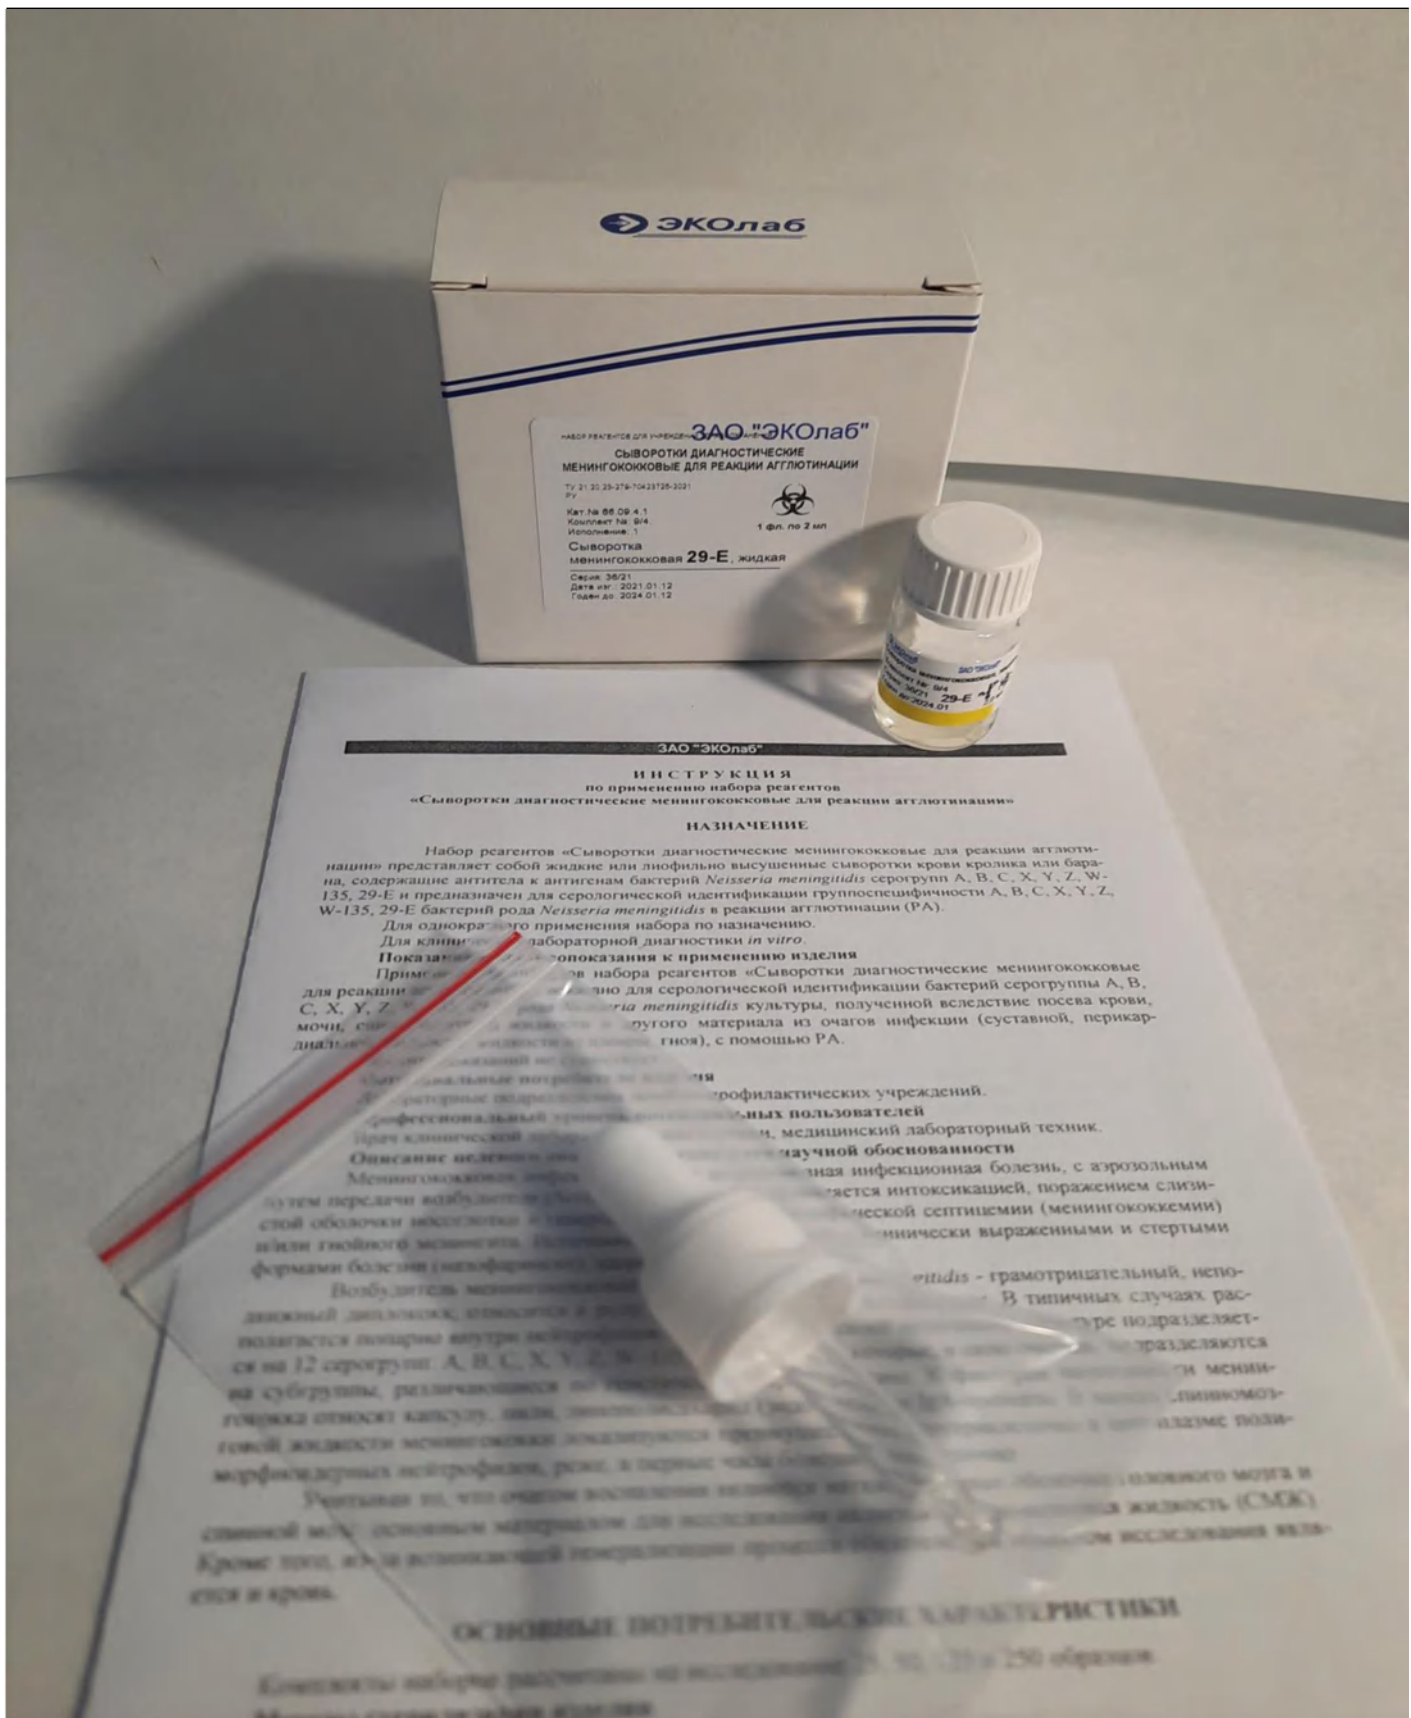


Комплект №2/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая А, сухая

серия 41/21 от 2021.01.12

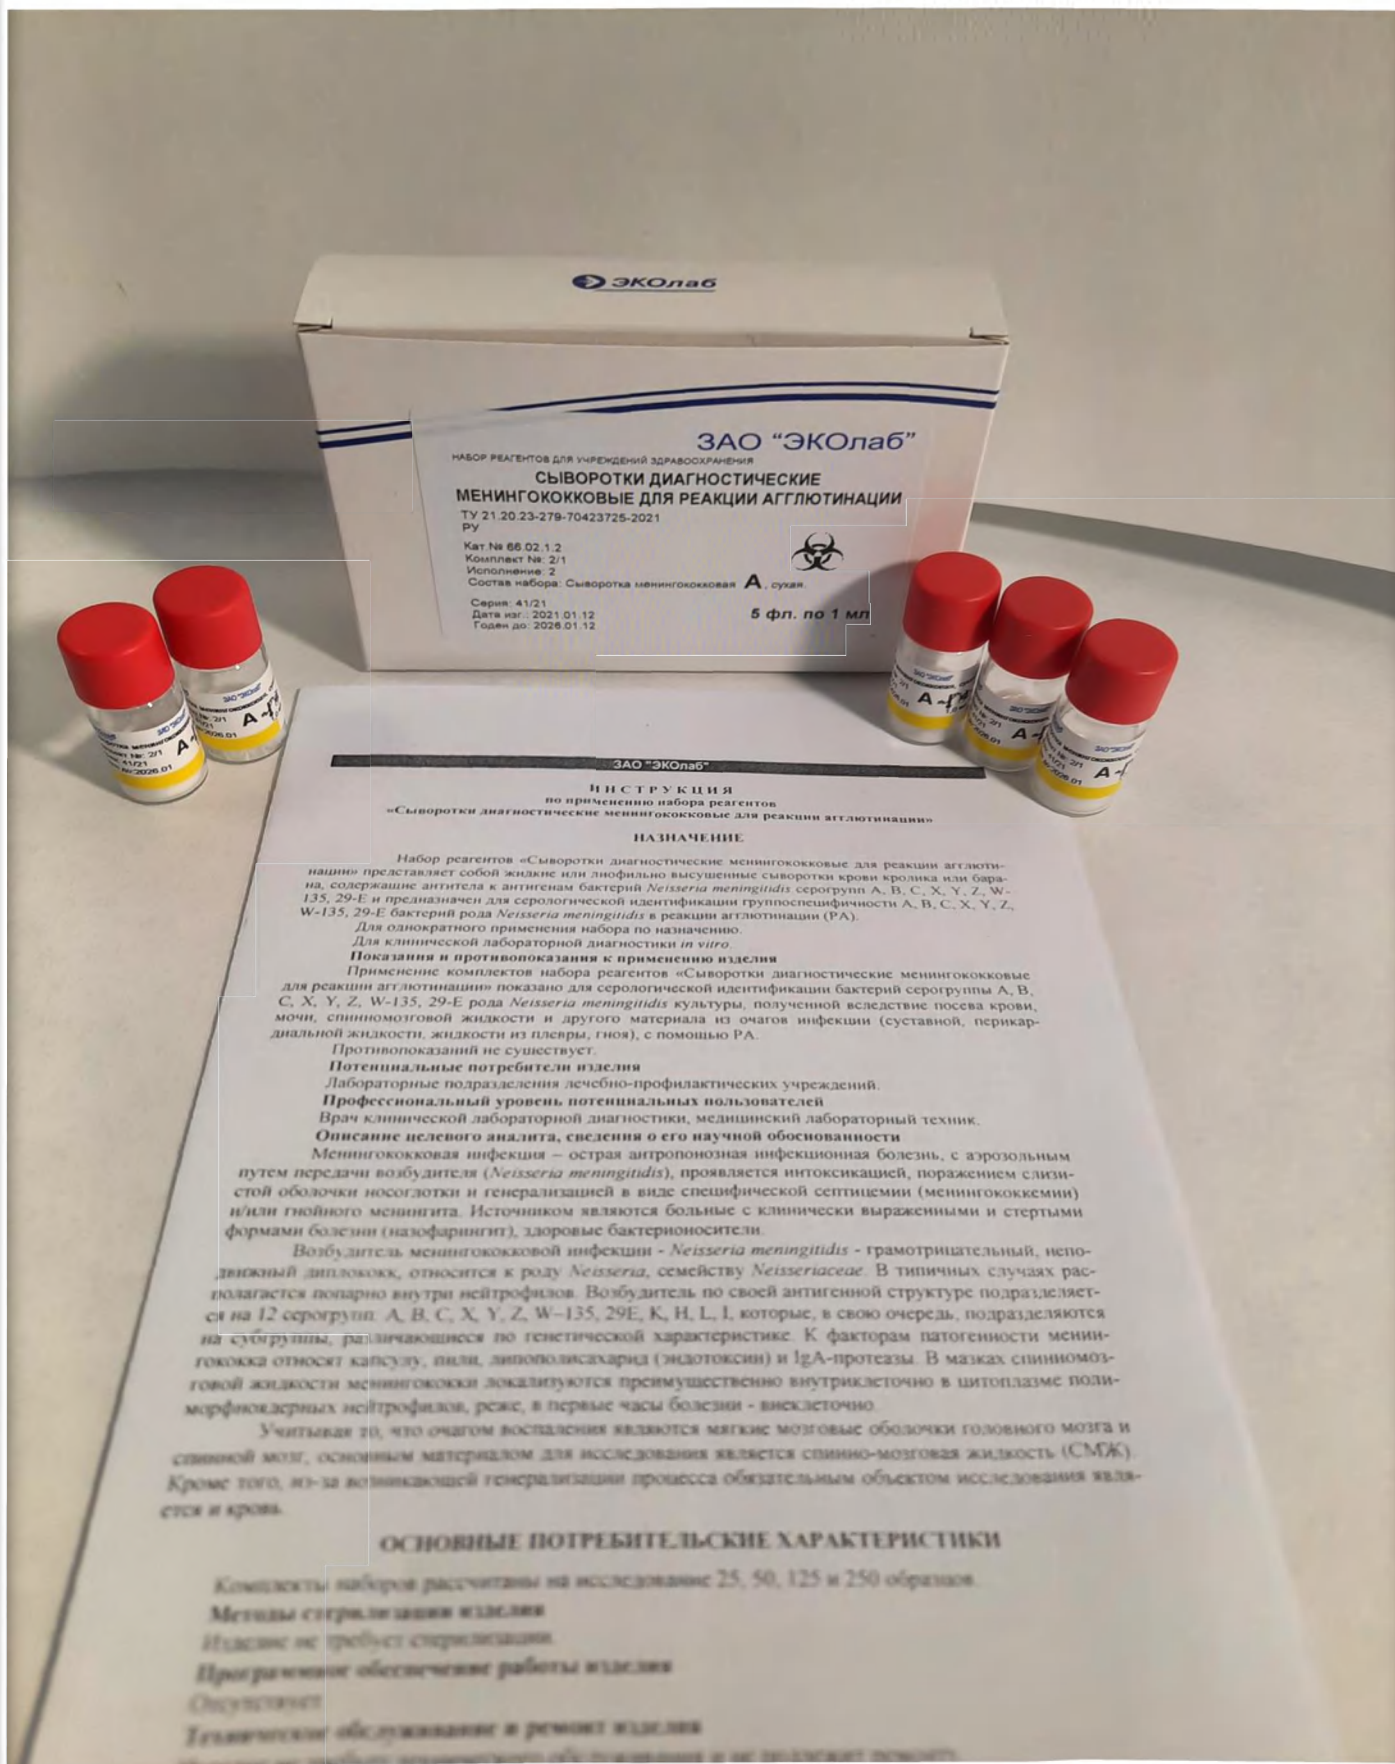

Комплект №2/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая А, сухая

серия 42/21 от 2021.01.12

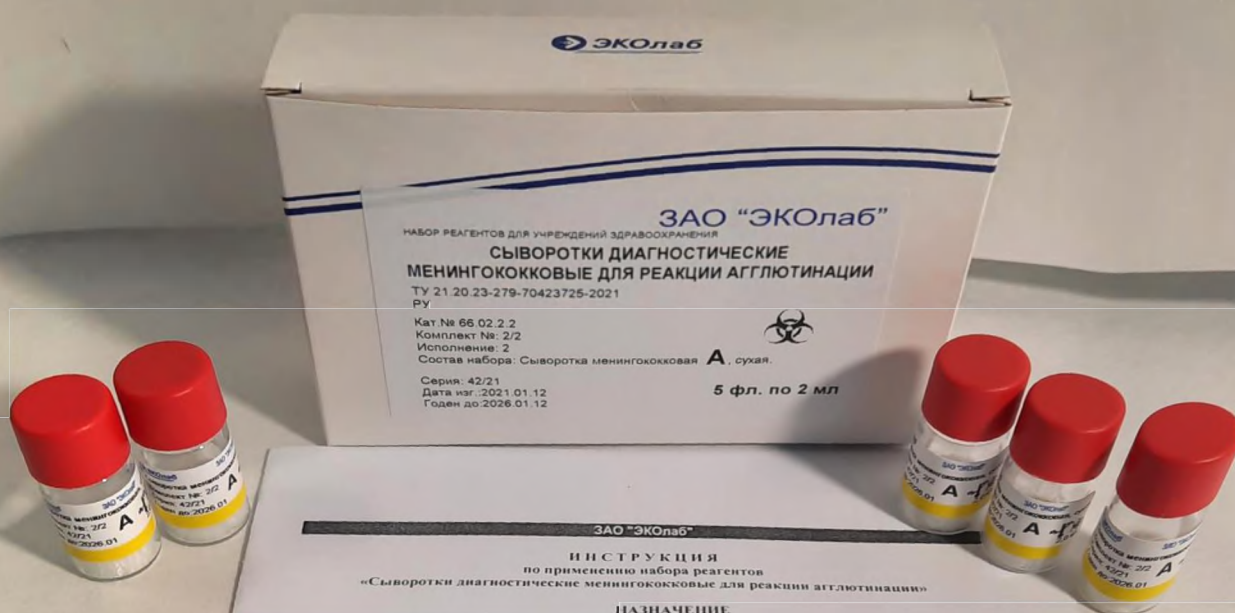

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*. В типичных случаях располагается парно внутри нейтрофилов. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29Е, К, Н, L, I, которые, в свою очередь, подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К факторам патогенности менингококка относят капсулу, пили, липополисахарид (эндоксин) и IgA-протеазы. В мазках спинномозговой жидкости менингококки локализуются преимущественно внутриклеточно в цитоплазме полиморфноядерных нейтрофилов, реже, в первые часы болезни – внеклеточно.

Учитывая то, что очагом воспаления являются мягкие мозговые оболочки головного мозга и спинного мозга, основным материалом для исследования является спинно-мозговая жидкость (СМЖ). Кроме того, из-за возникающей генерализации процесса обязательным объектом исследования является и кровь.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплекты наборов рассчитаны на исследование 25, 50, 125 и 250 образцов.

Методы стерилизации изделия

Изделие не требует стерилизации.


Комплект №2/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая А, жидкая

серия 43/21 от 2021.01.12

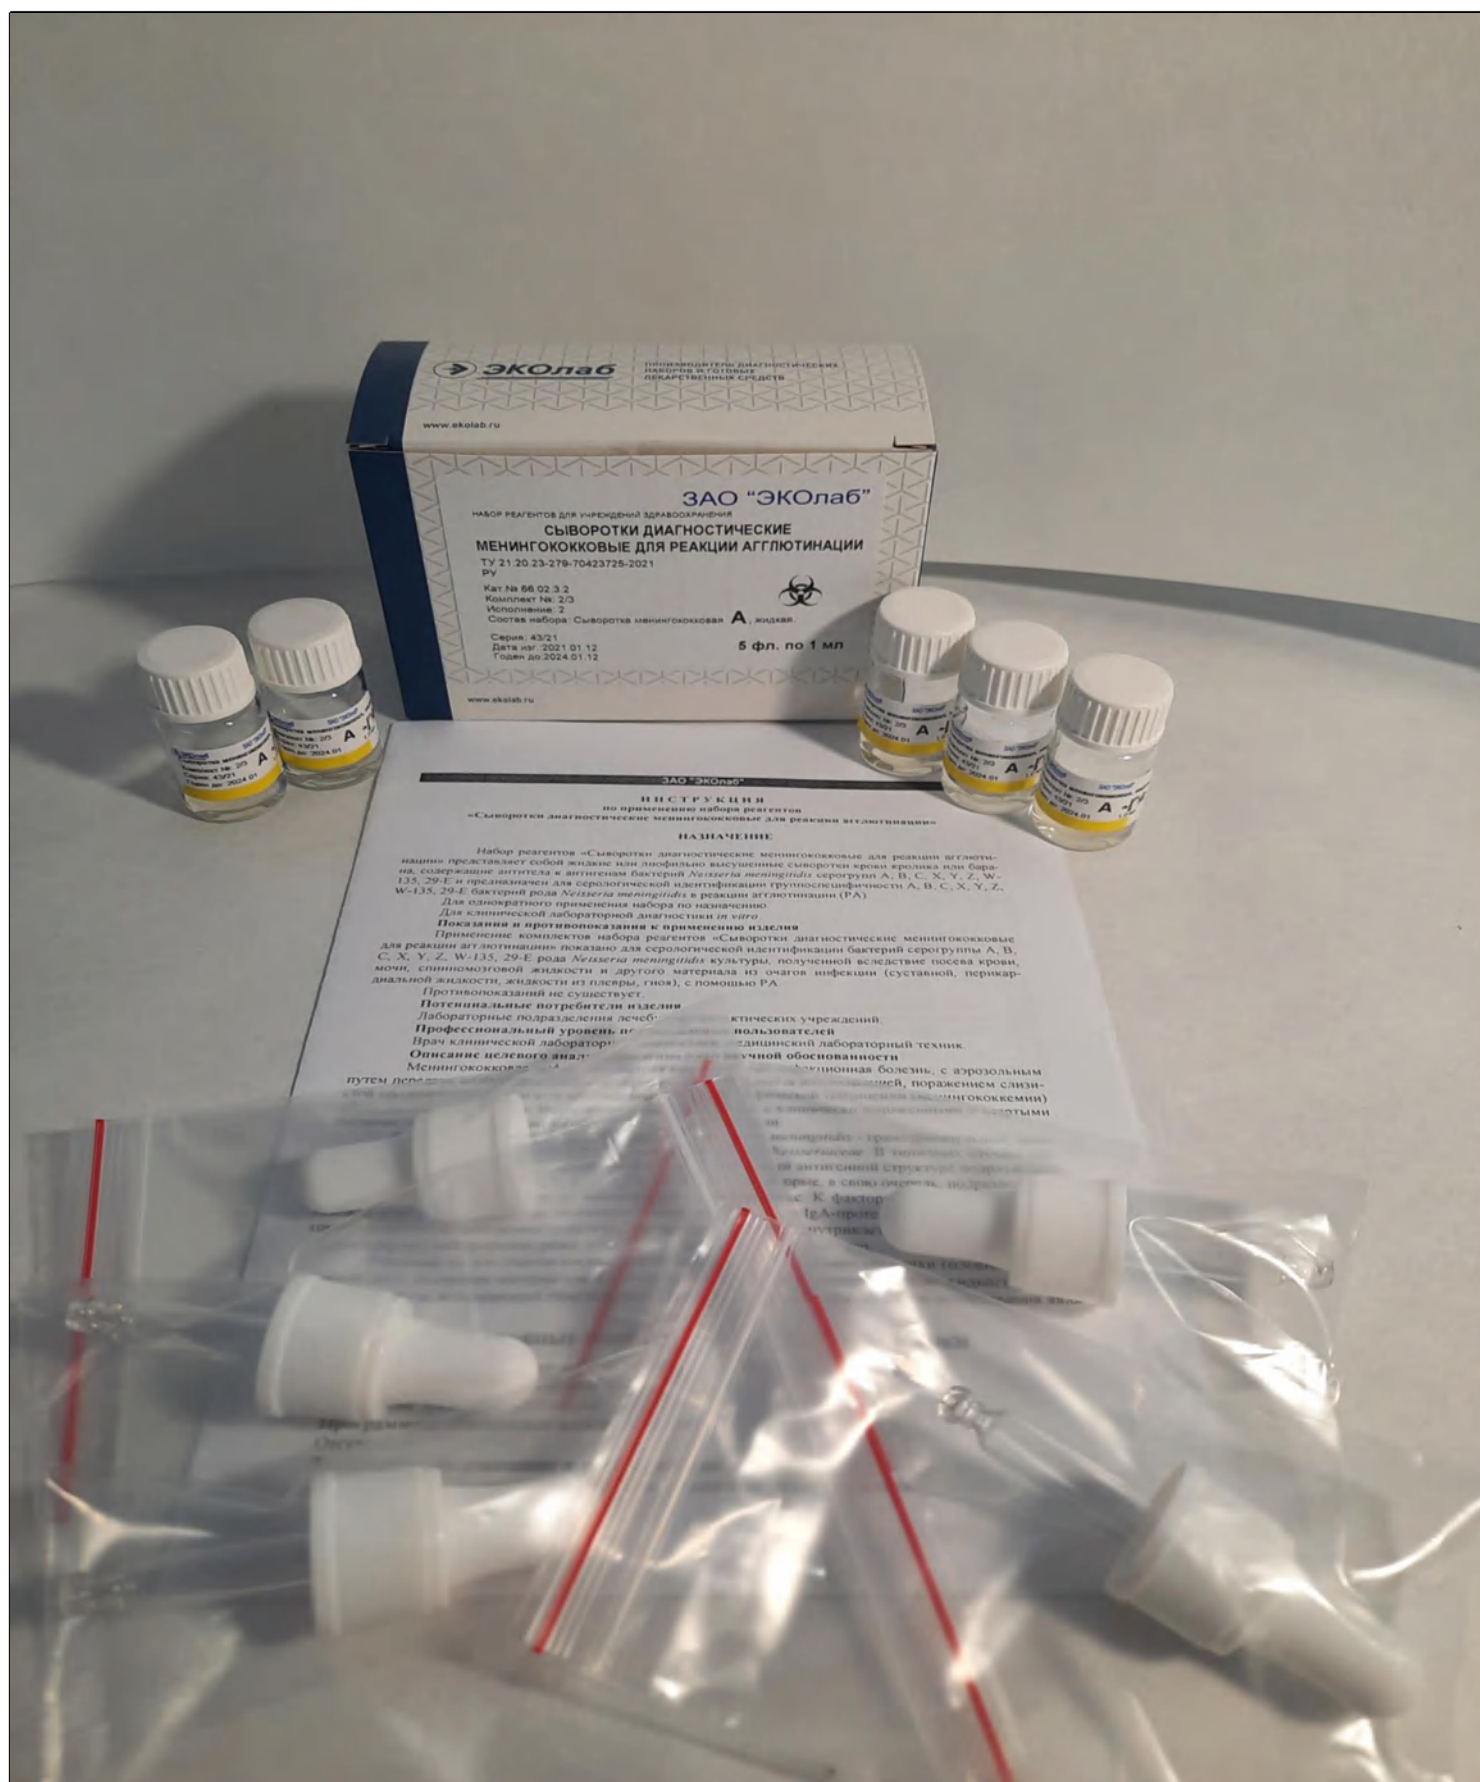


Комплект №2/4, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая А, жидкая

серия 44/21 от 2021.01.12

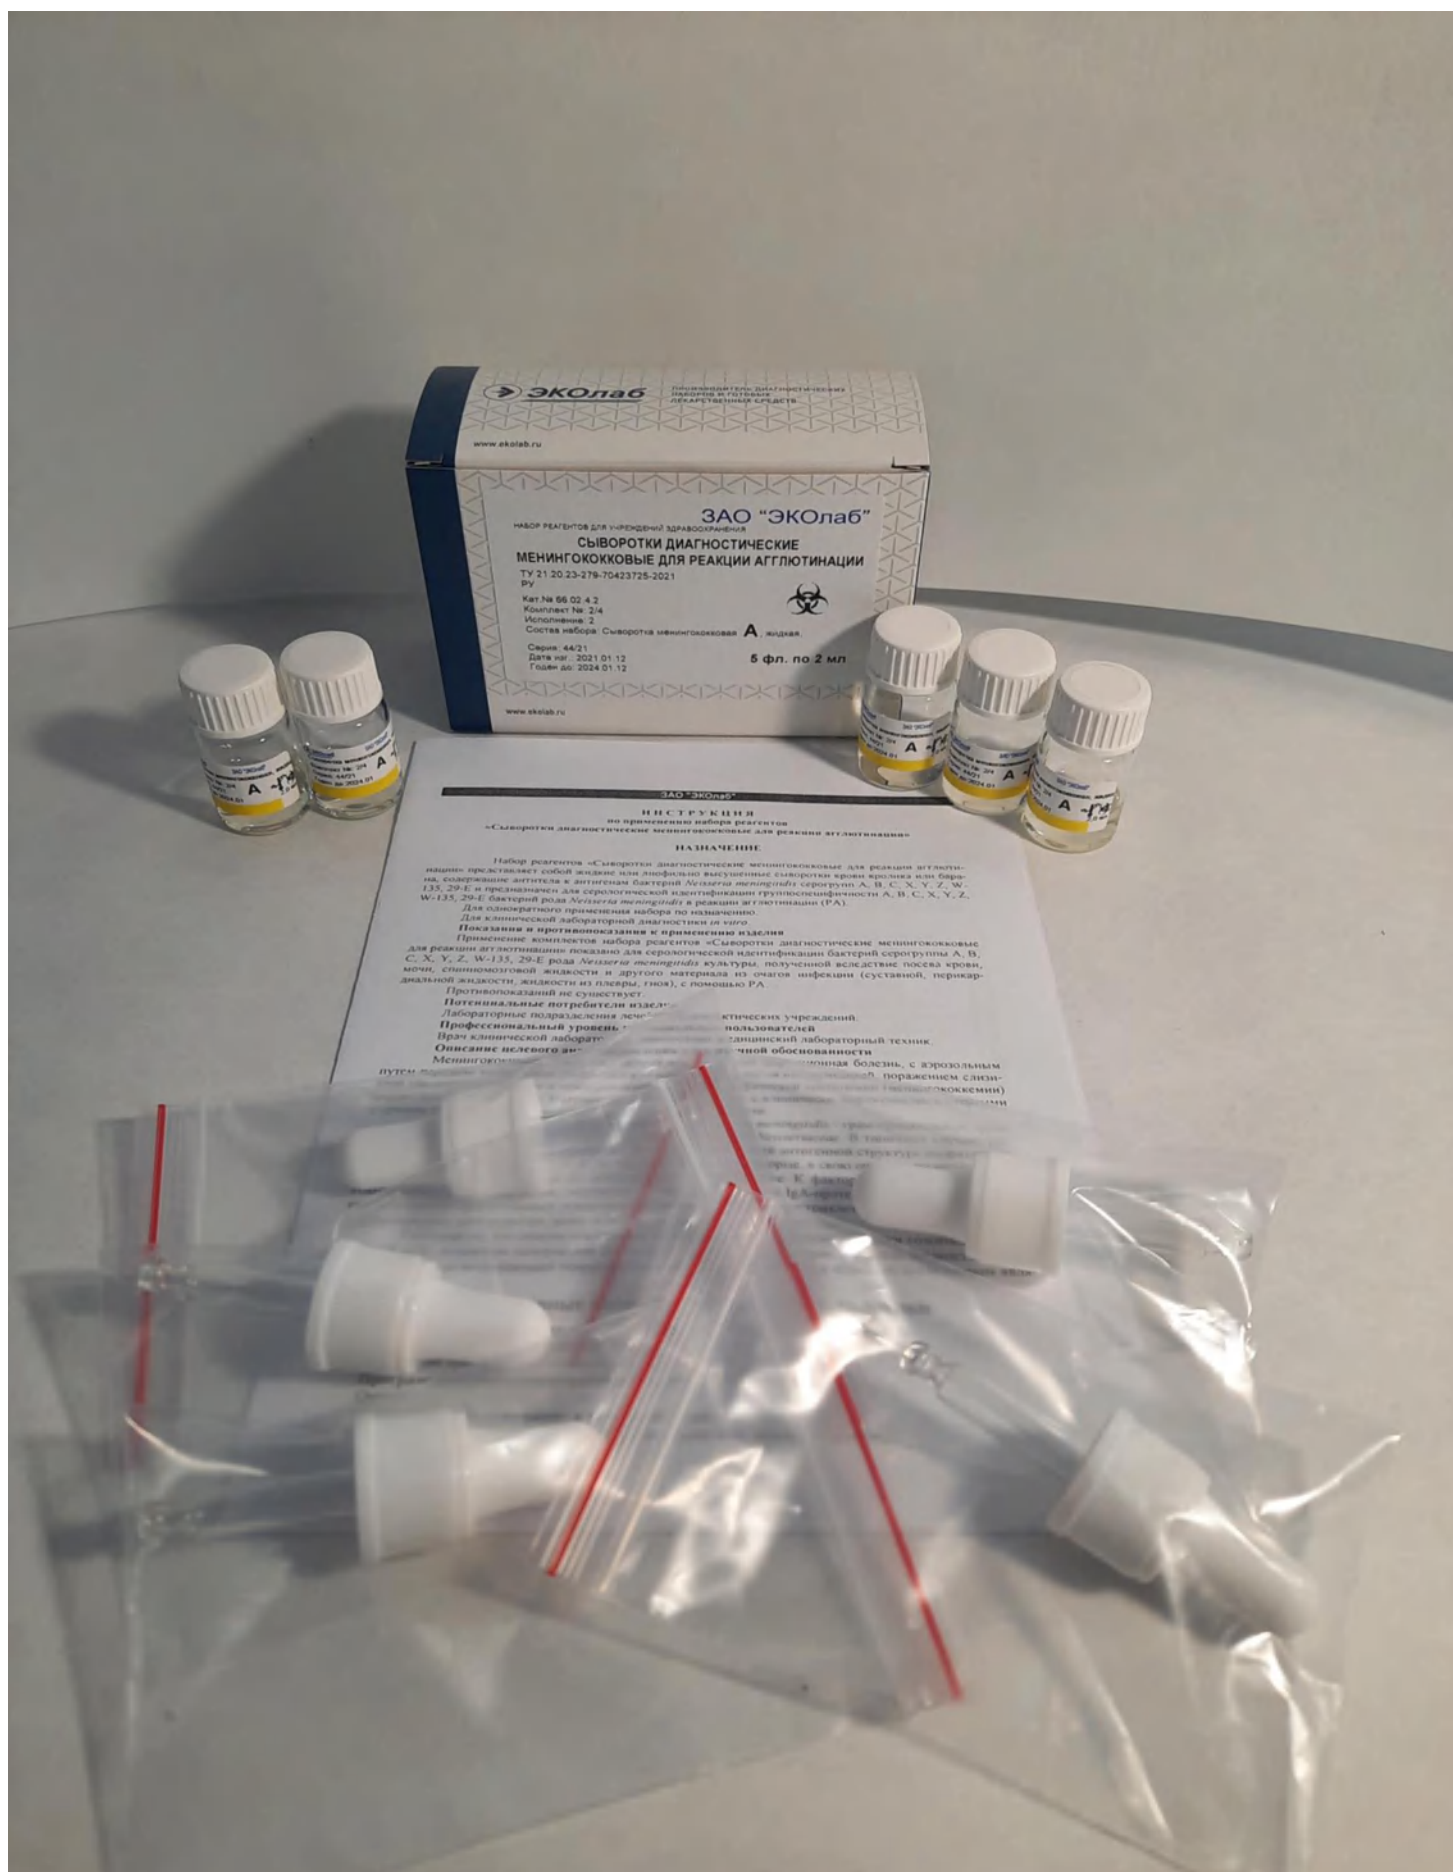


Комплект №3/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая В, сухая

серия 45/21 от 2021.01.12

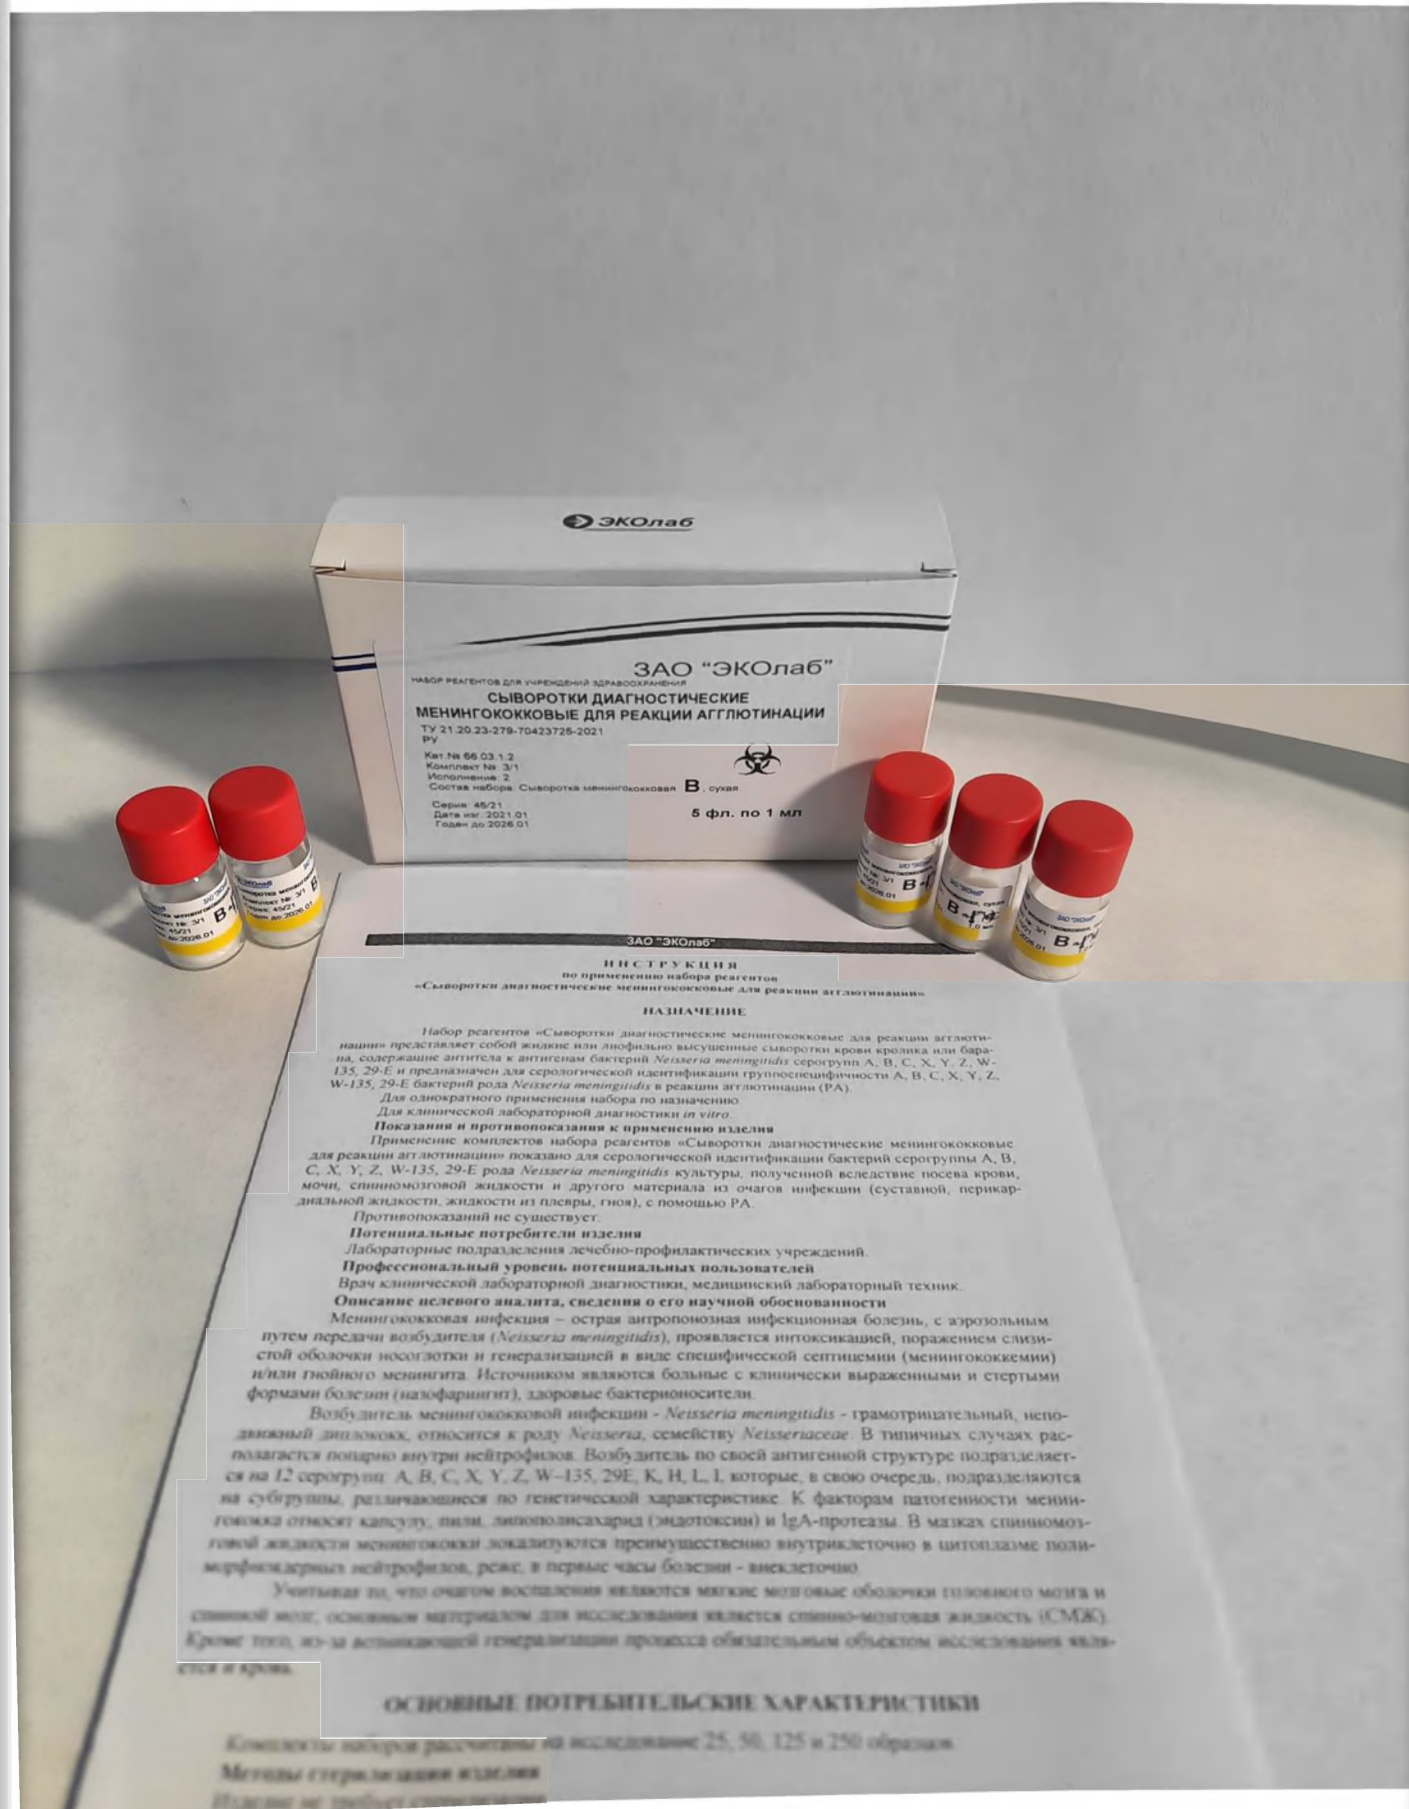


Комплект №3/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая В, сухая

серия 46/21 от 2021.01.12

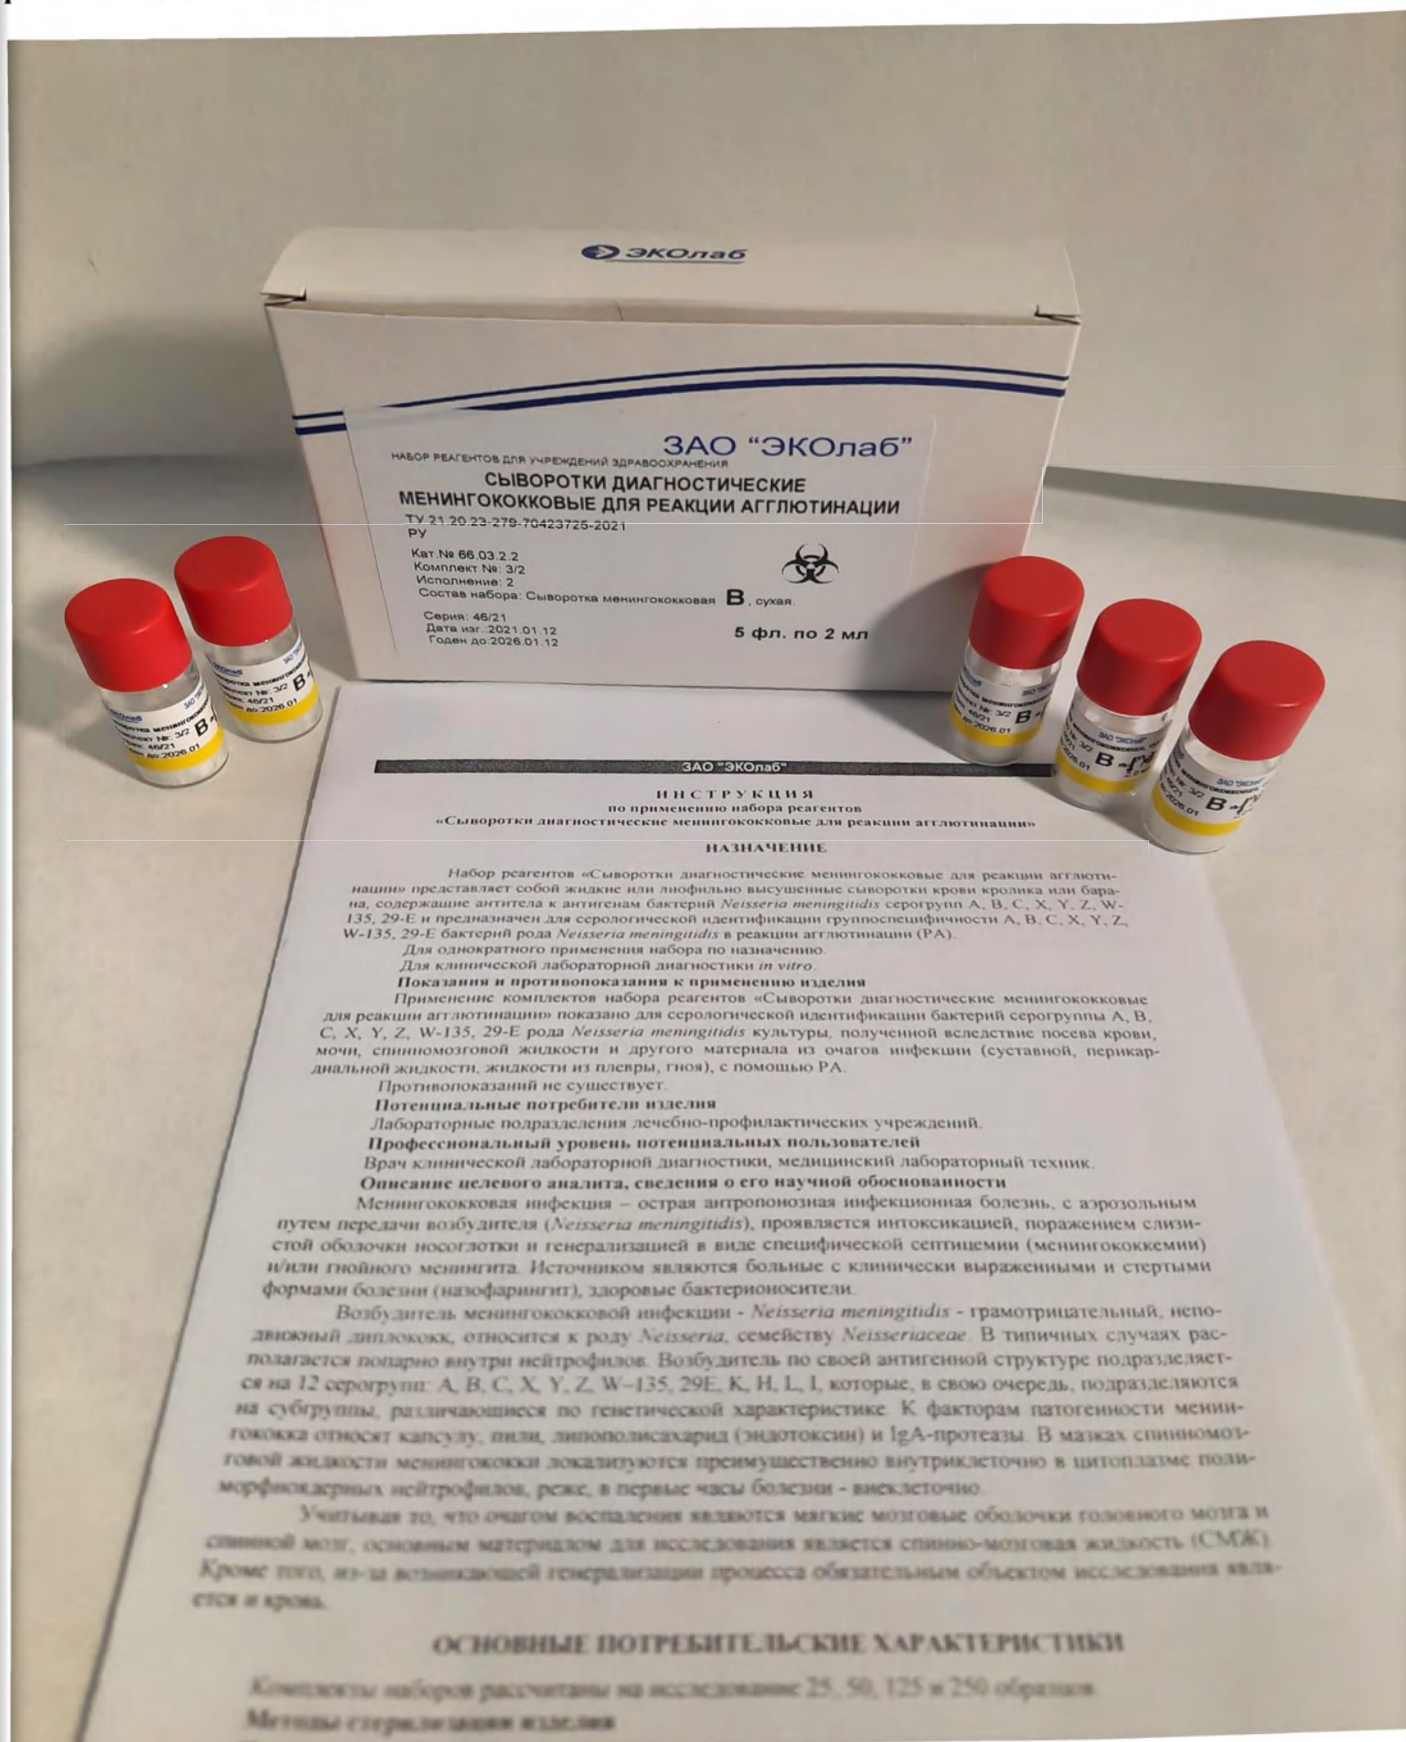


Комплект №3/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая В, жидкая

серия 47/21 от 2021.01.12

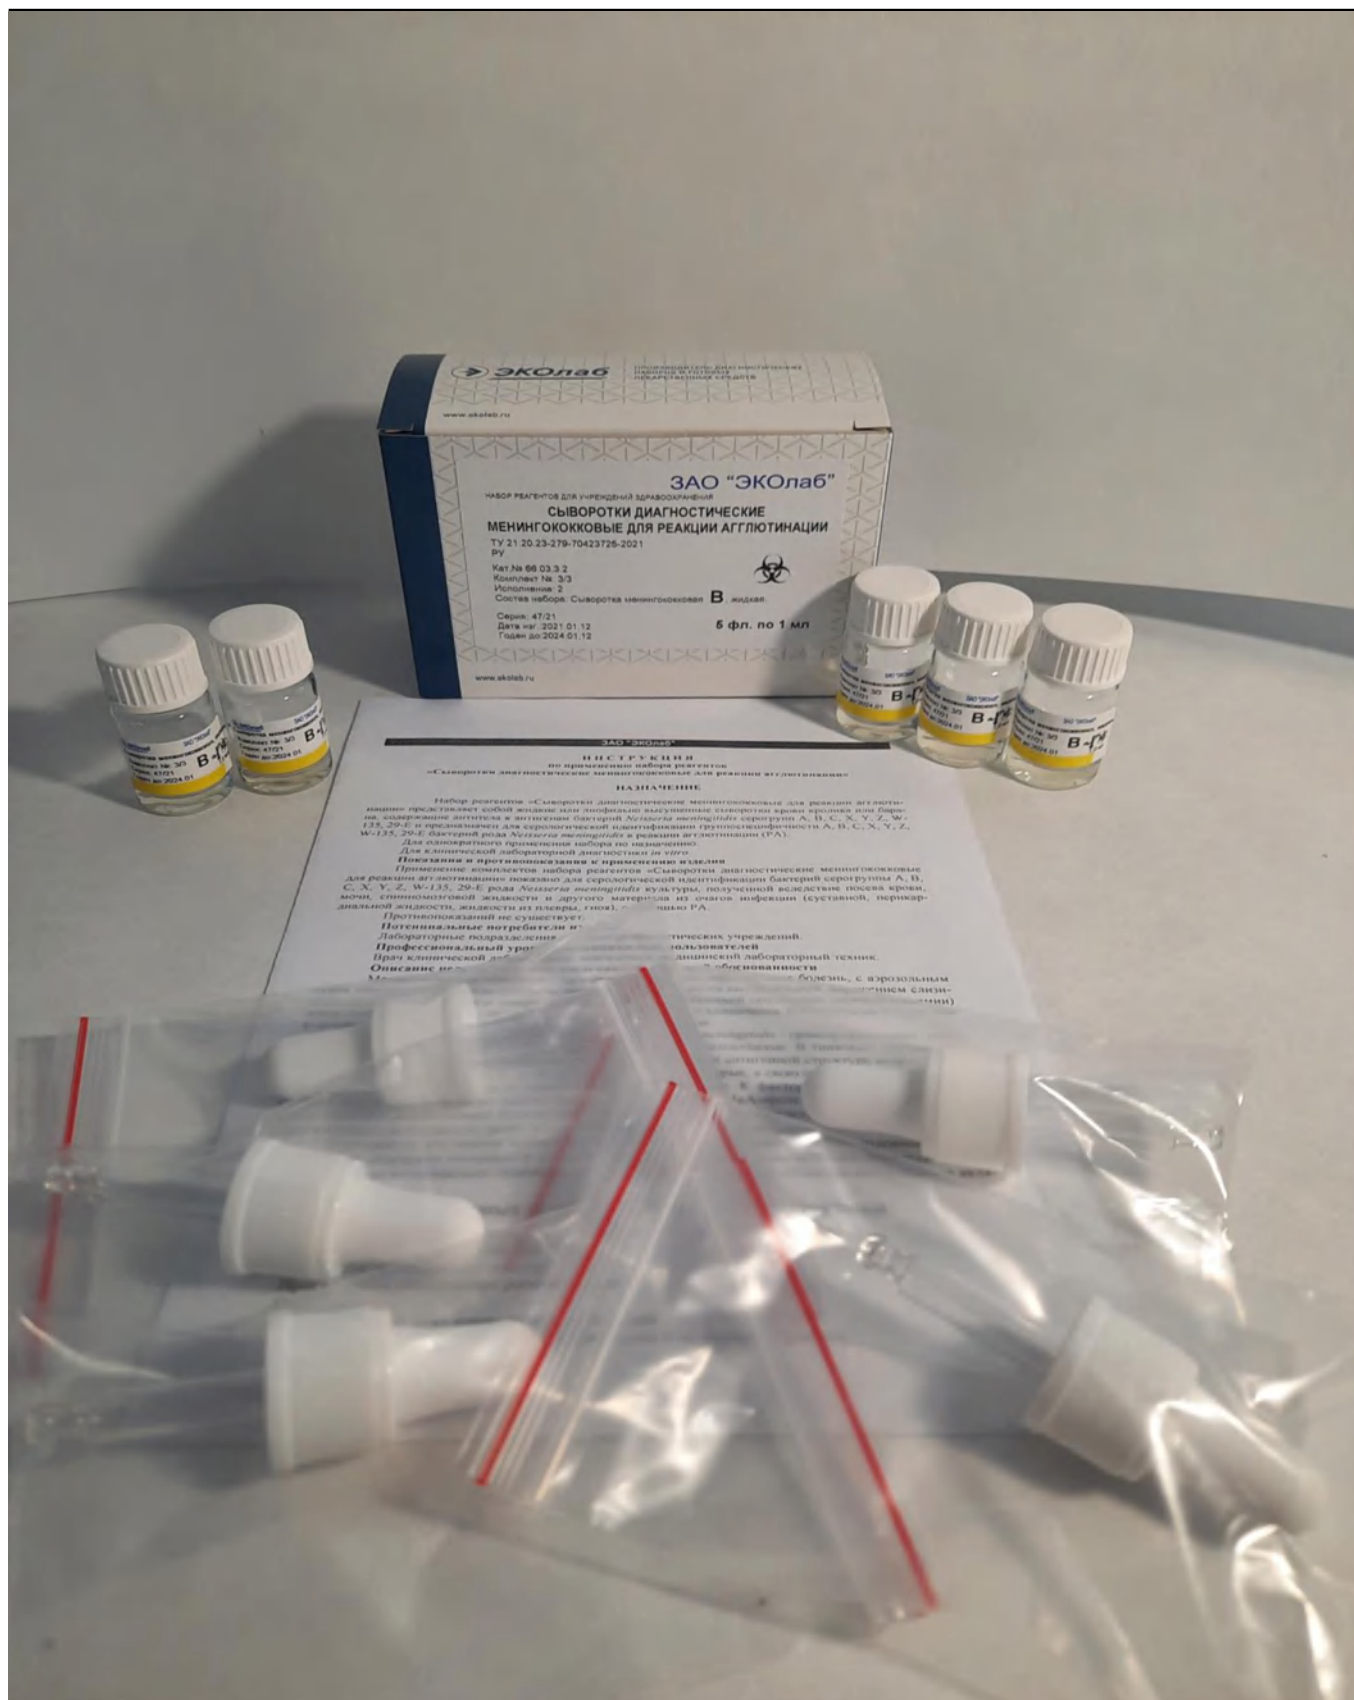


Комплект №3/4, Исполнение 2 Сыворотка менингококковая В, жидкая

серия 48/21 от 2021.01.12

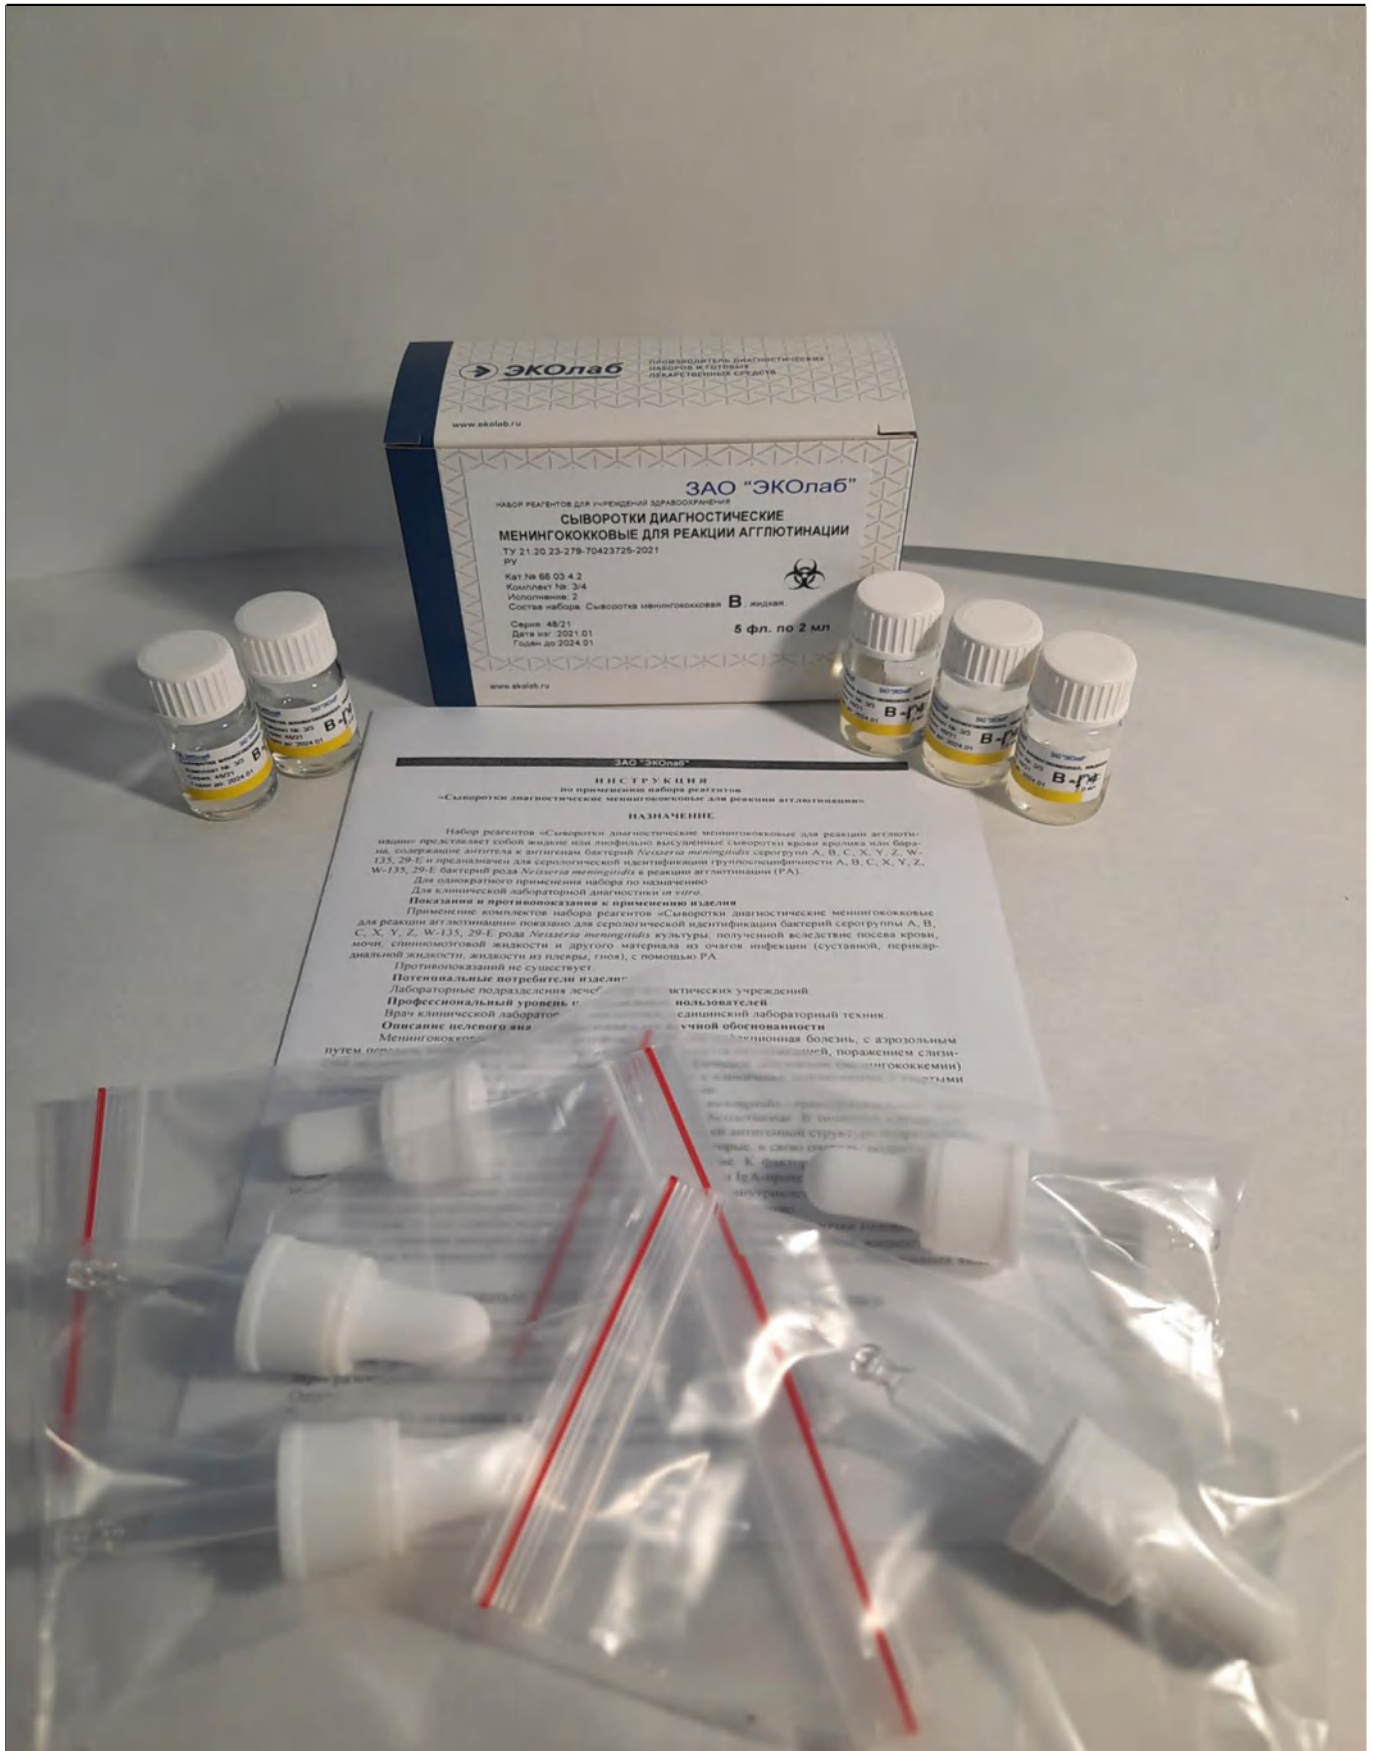


Комплект №4/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая С, сухая

серия 49/21 от 2021.01.12

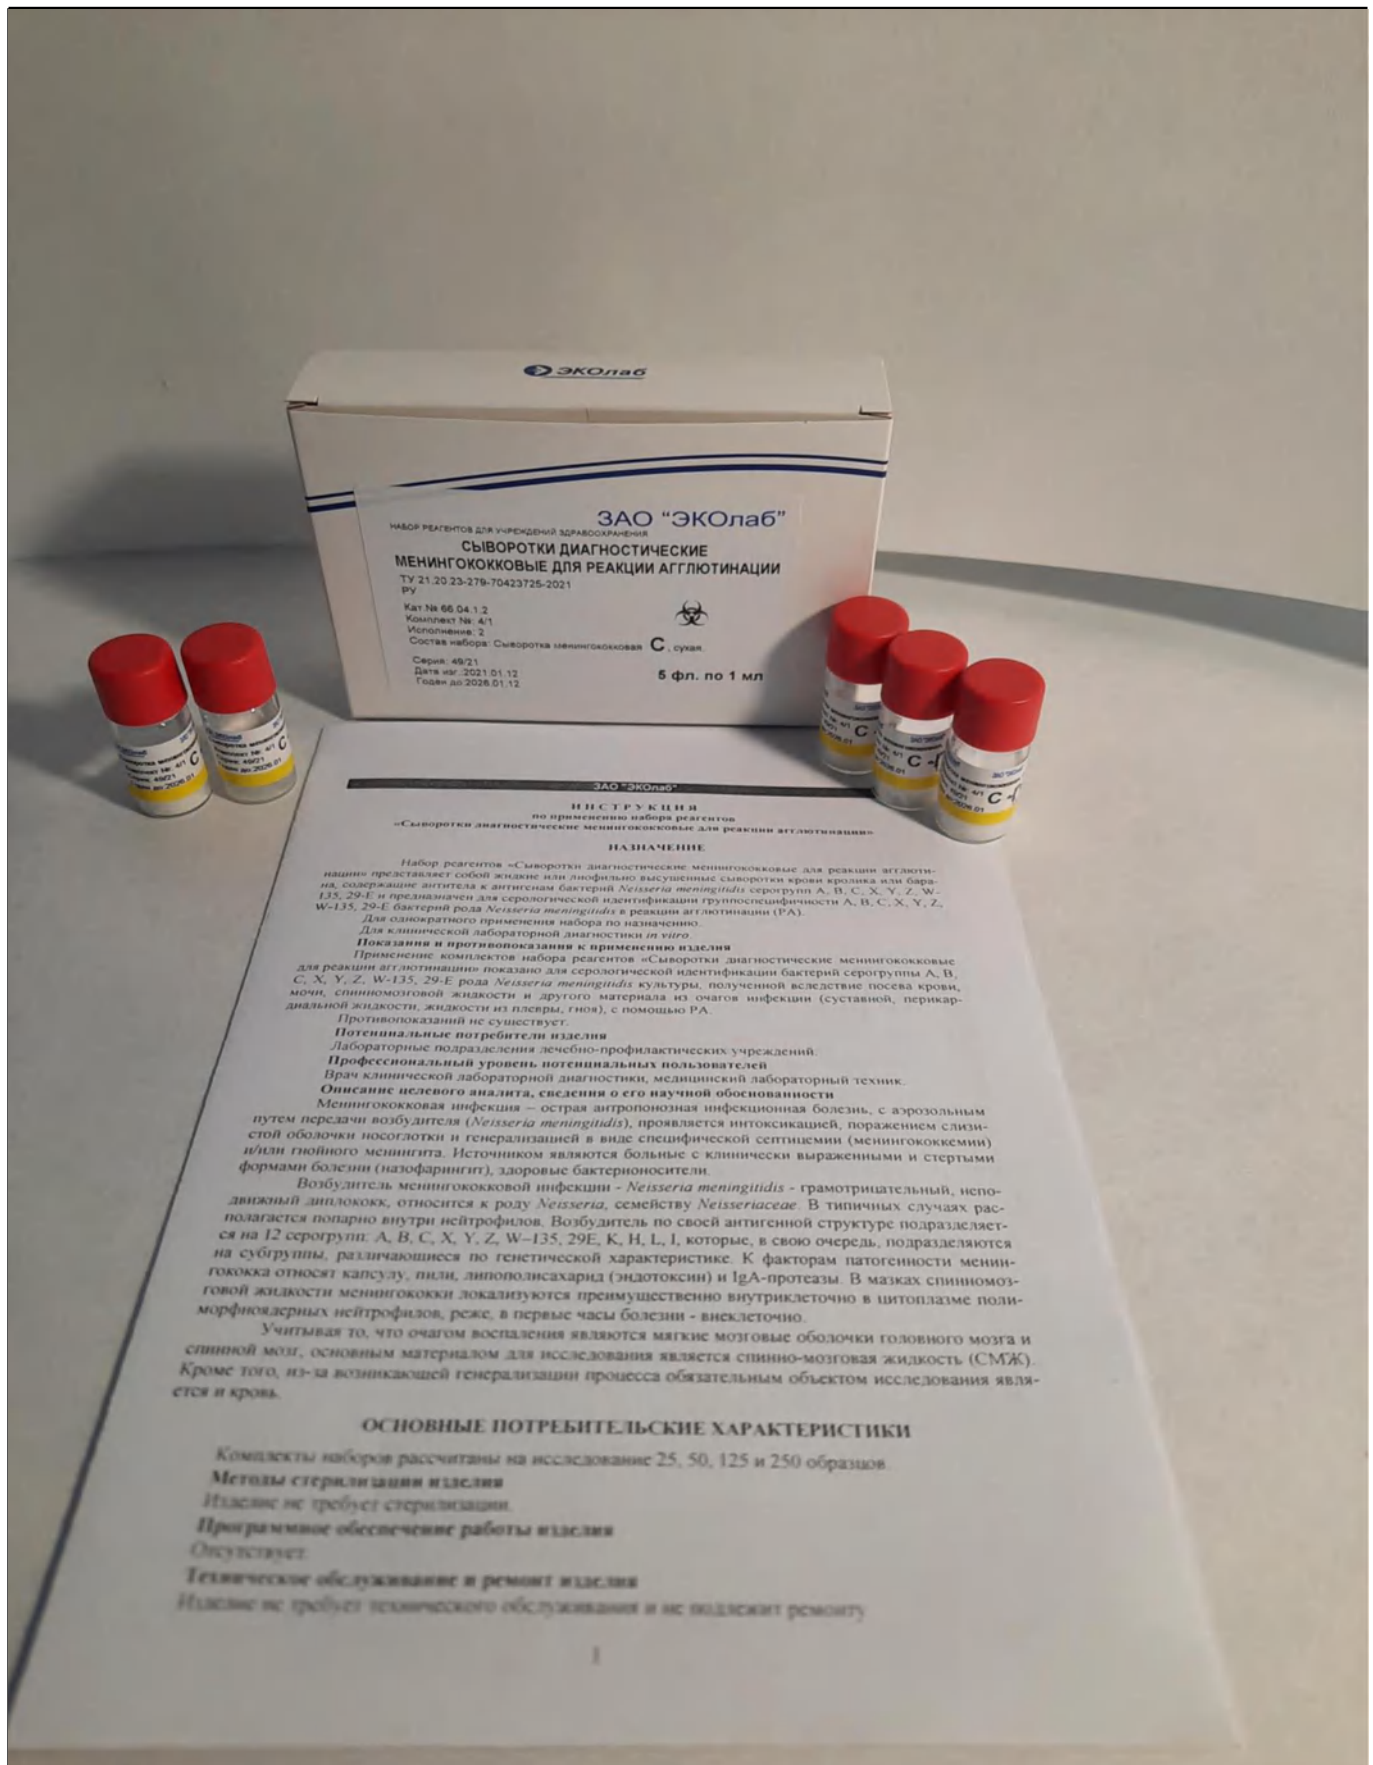


Комплект №4/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая С, сухая


серия 50/21 от 2021.01.12

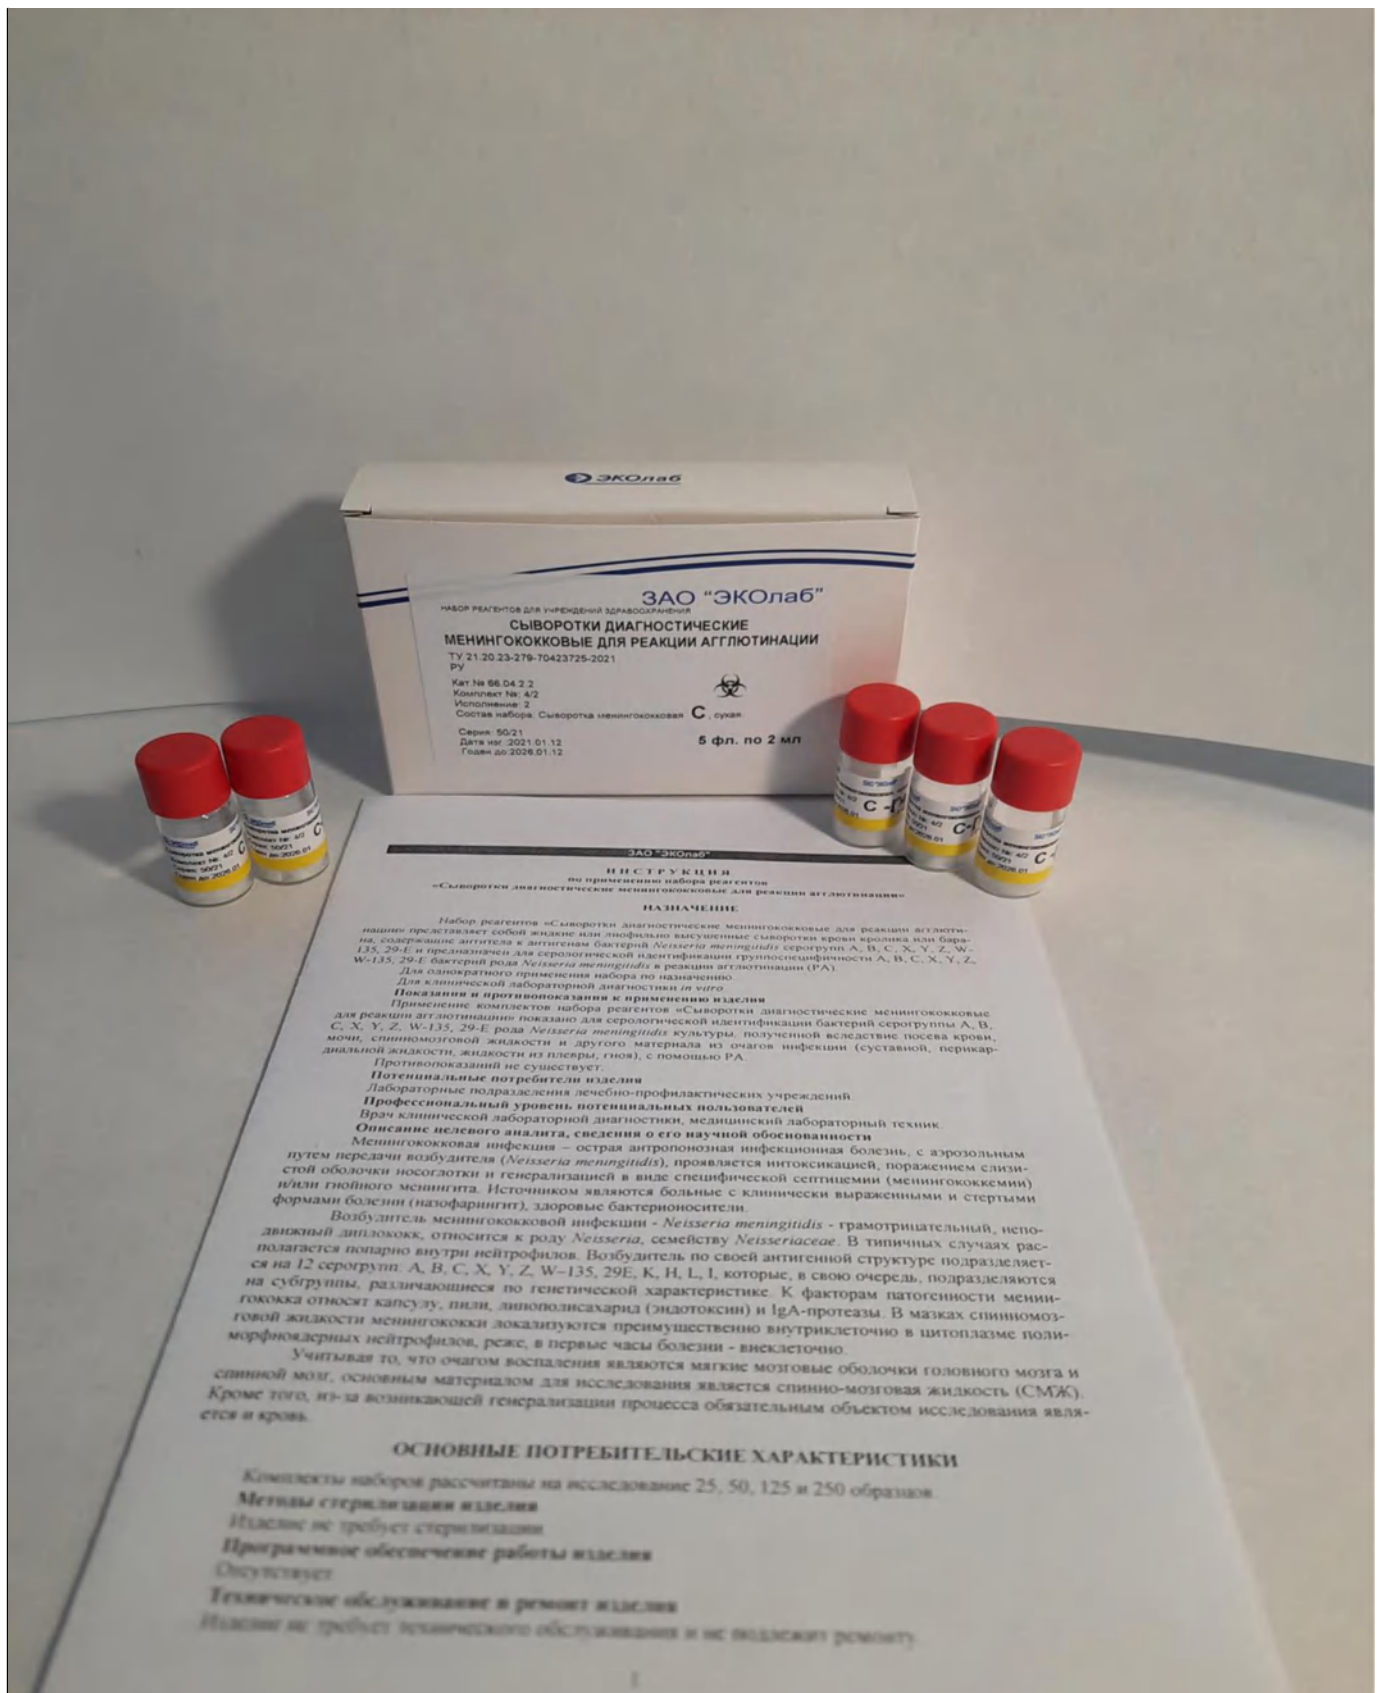

Комплект №4/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая С, жидкая
серия 51/21 от 2021.01.12

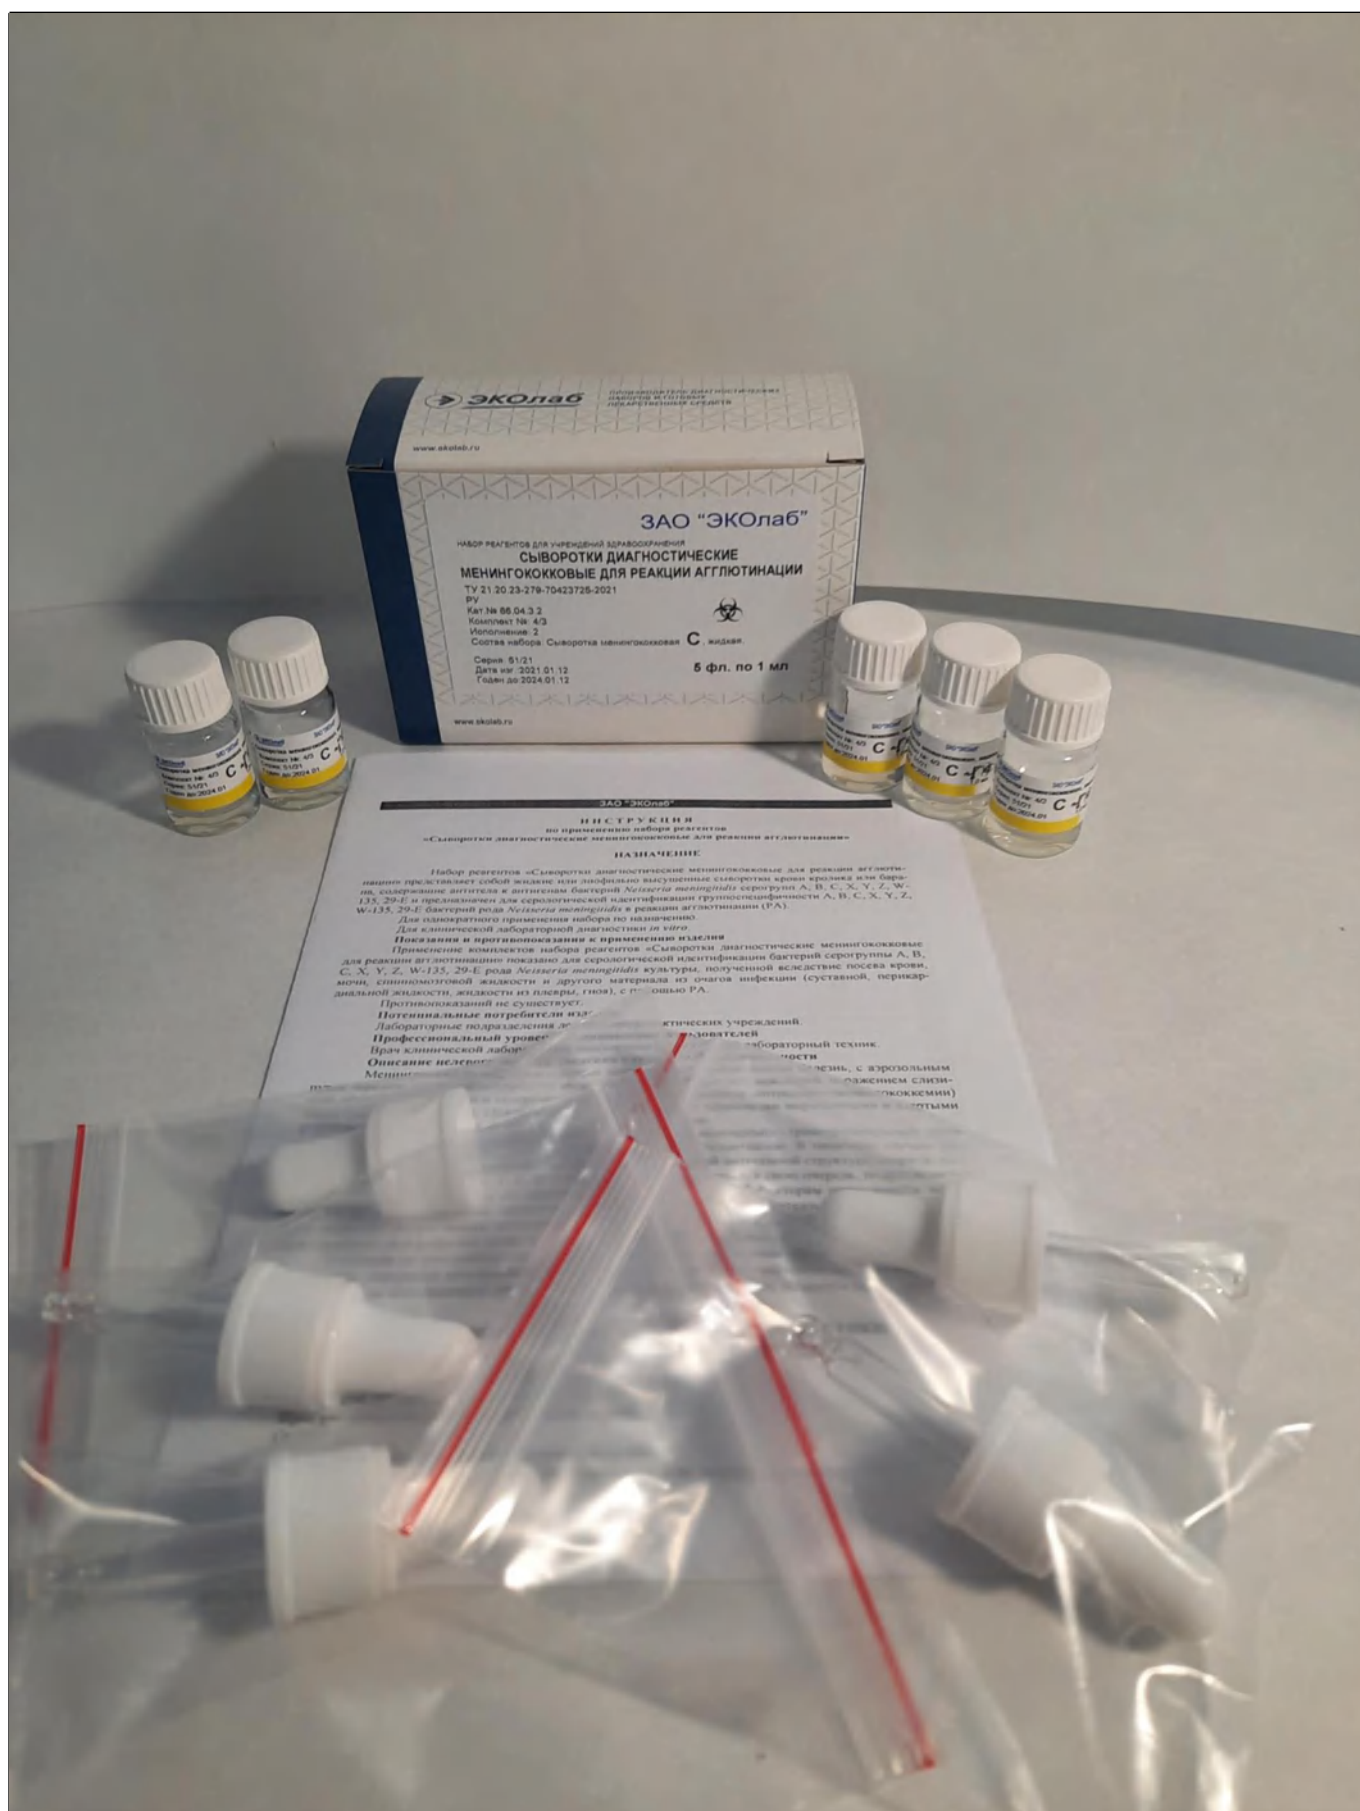


Комплект №4/4, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая С, жидкая
серия 52/21 от 2021.01.12

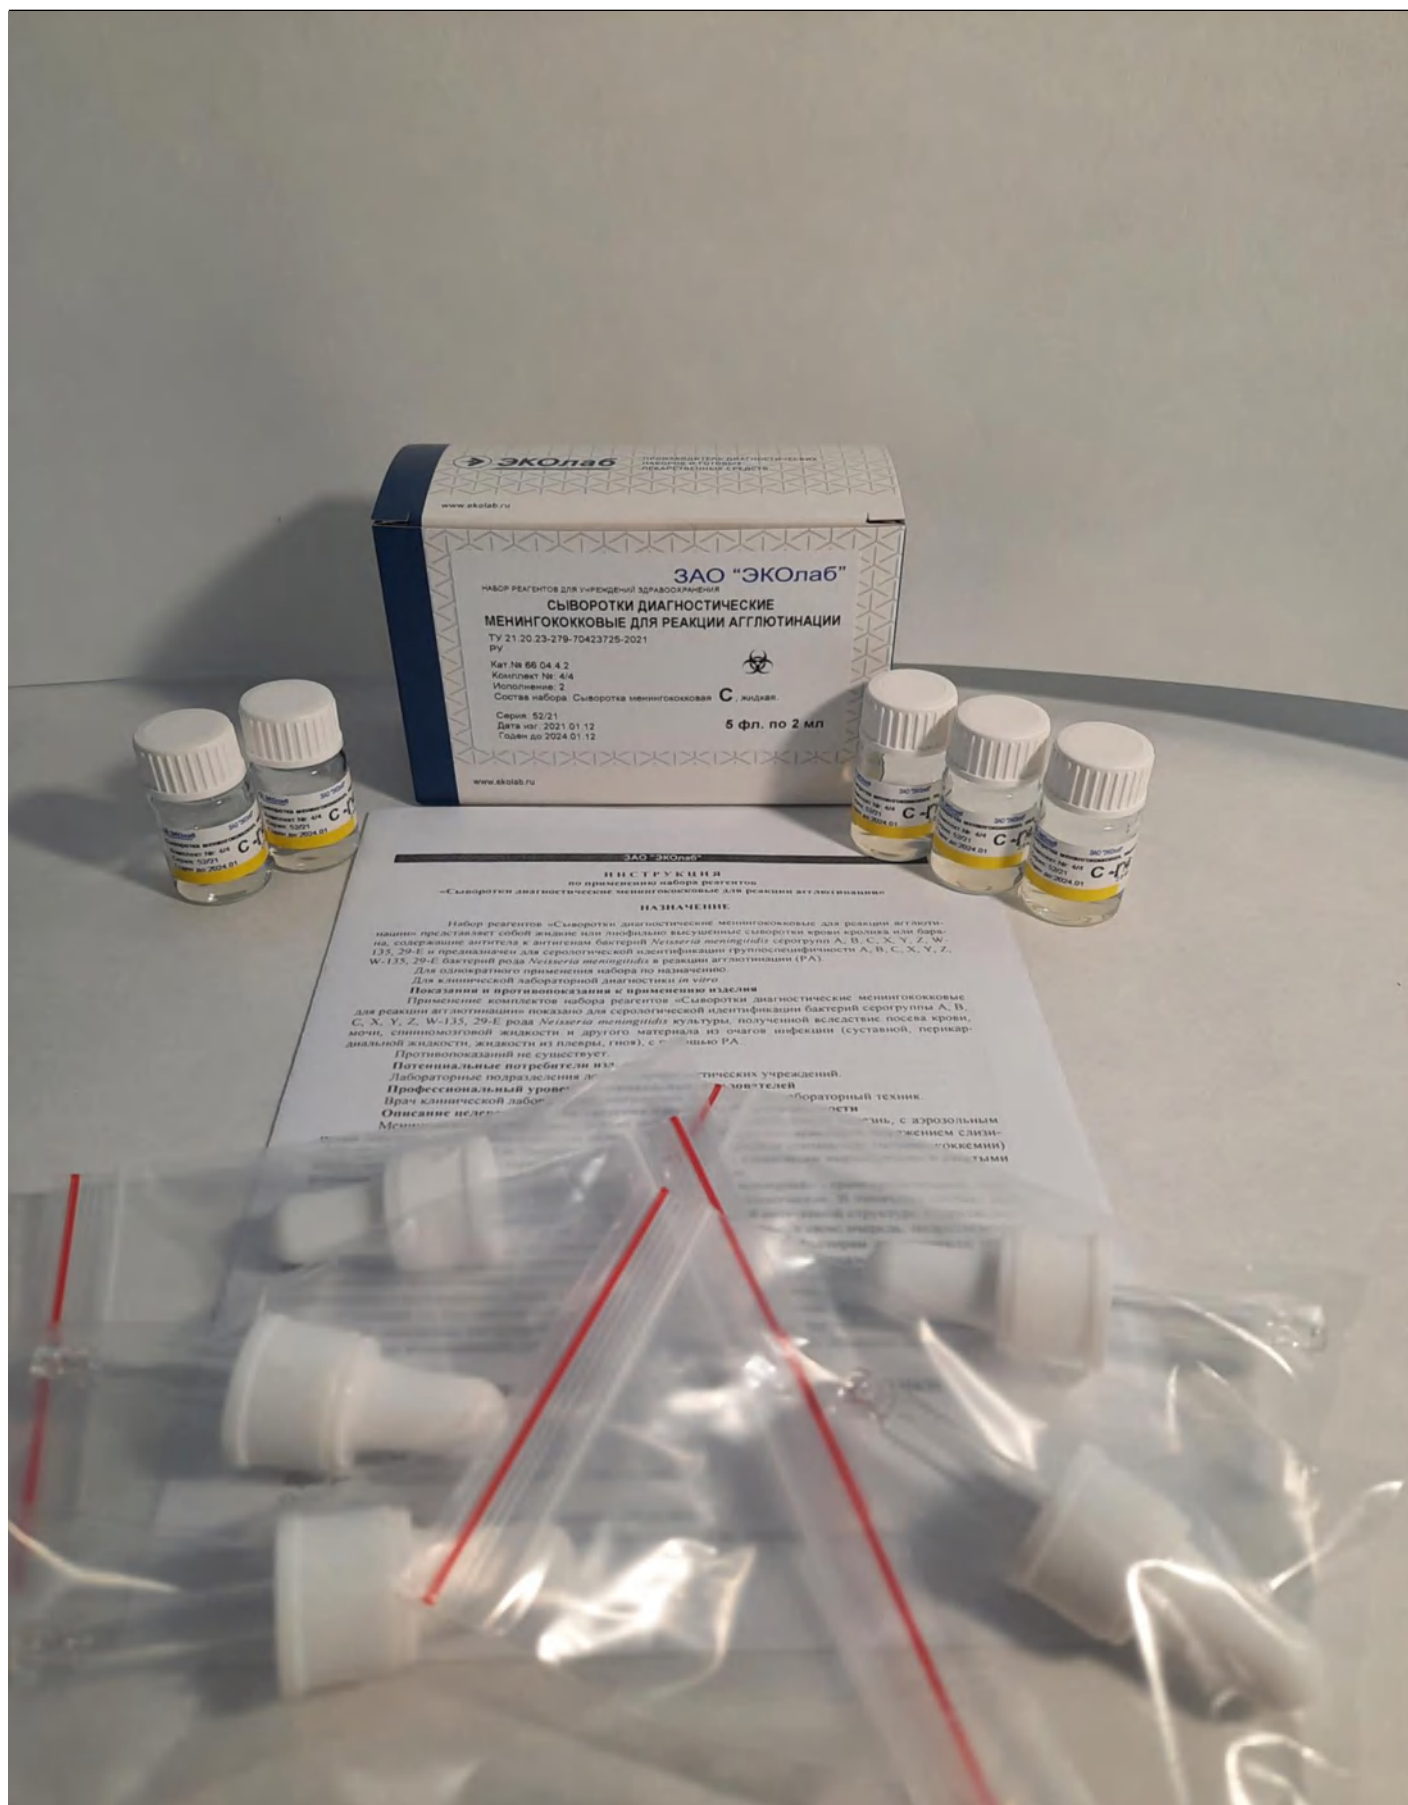


Комплект №5/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая X, сухая

серия 53/21 от 2021.01.12

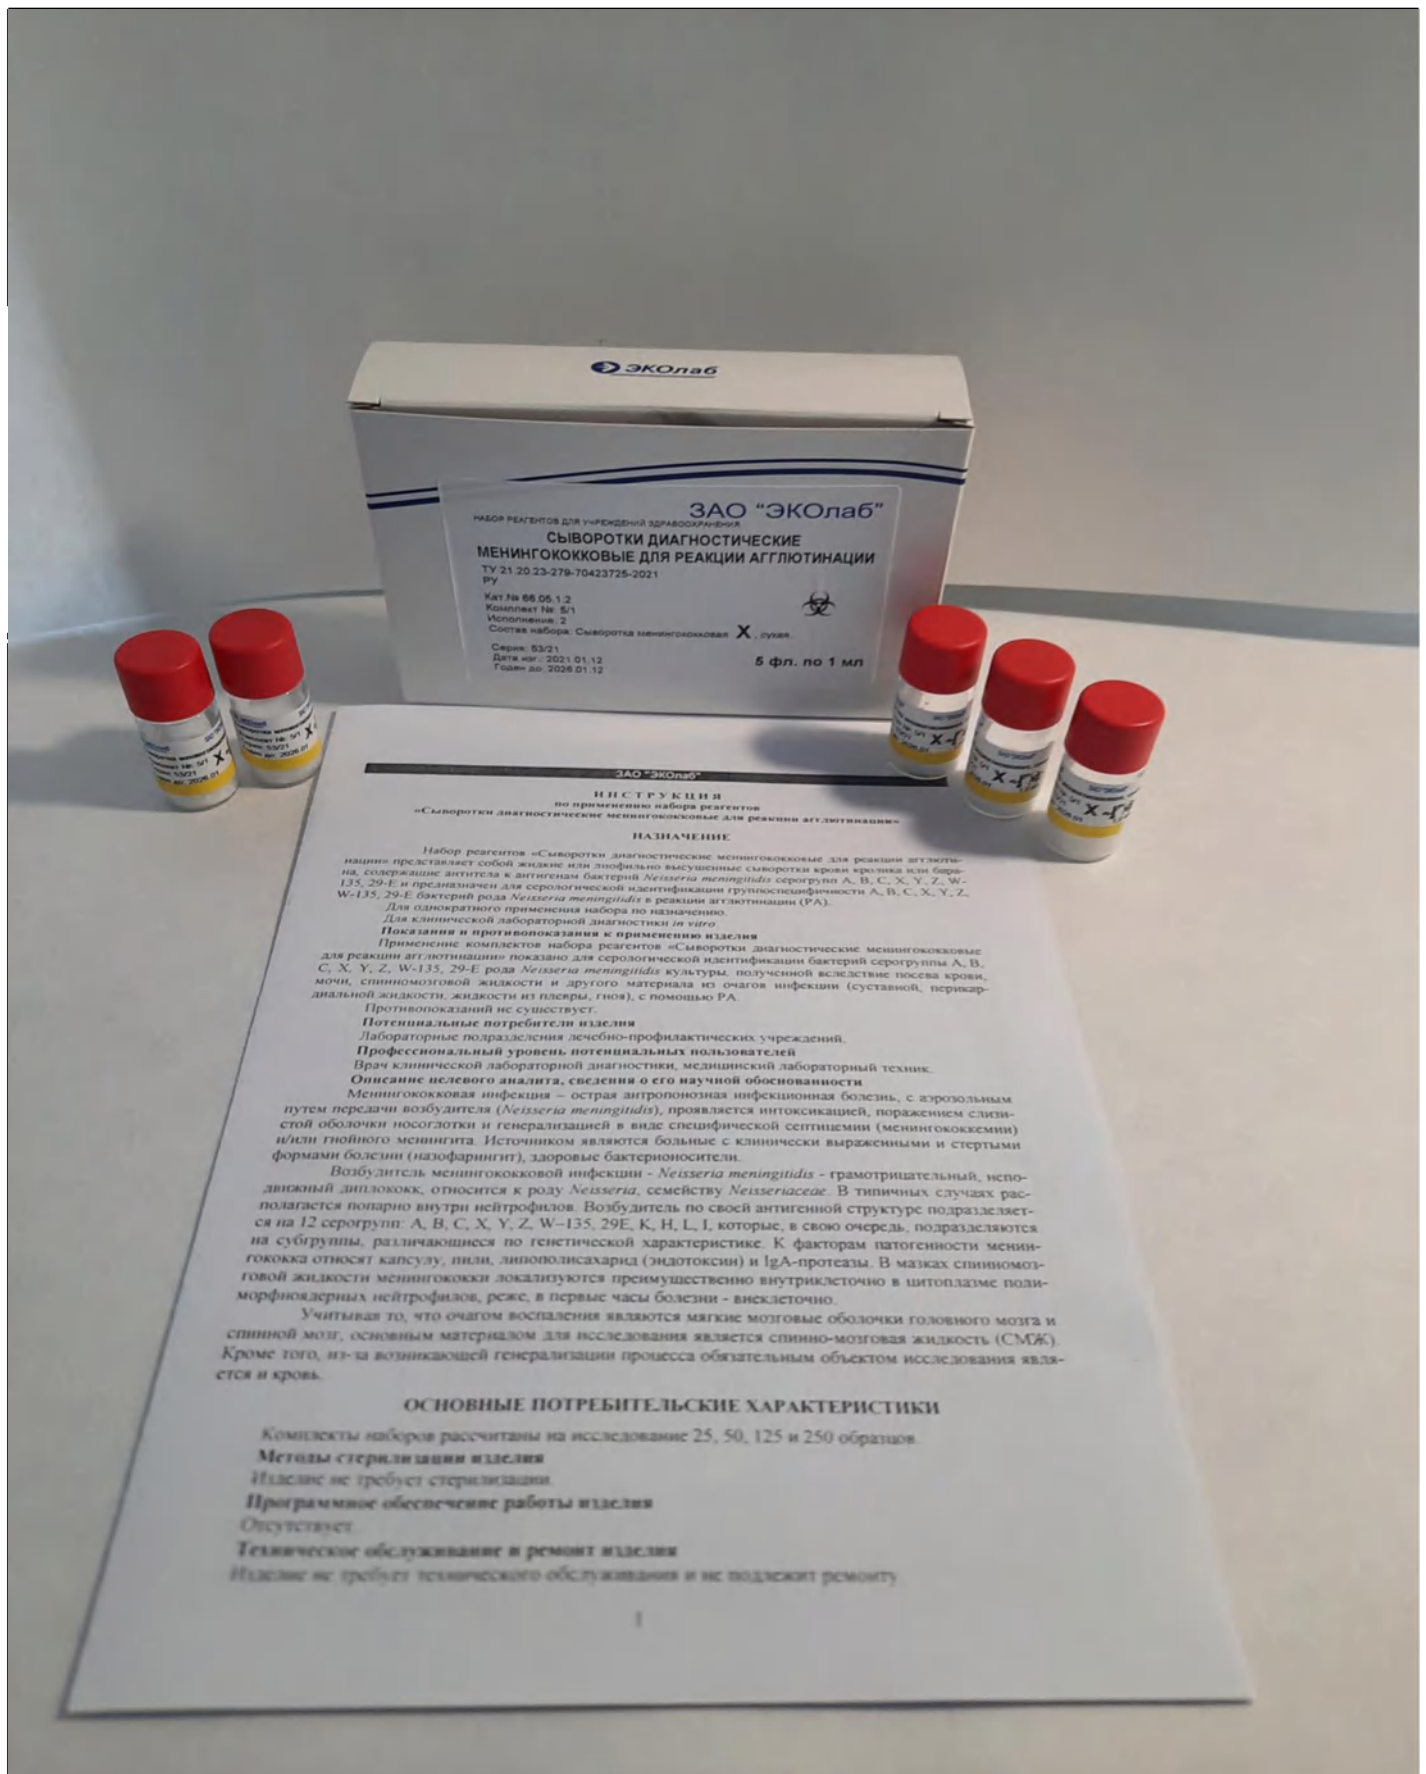


Комплект №5/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая X, сухая

серия 54/21 от 2021.01.12

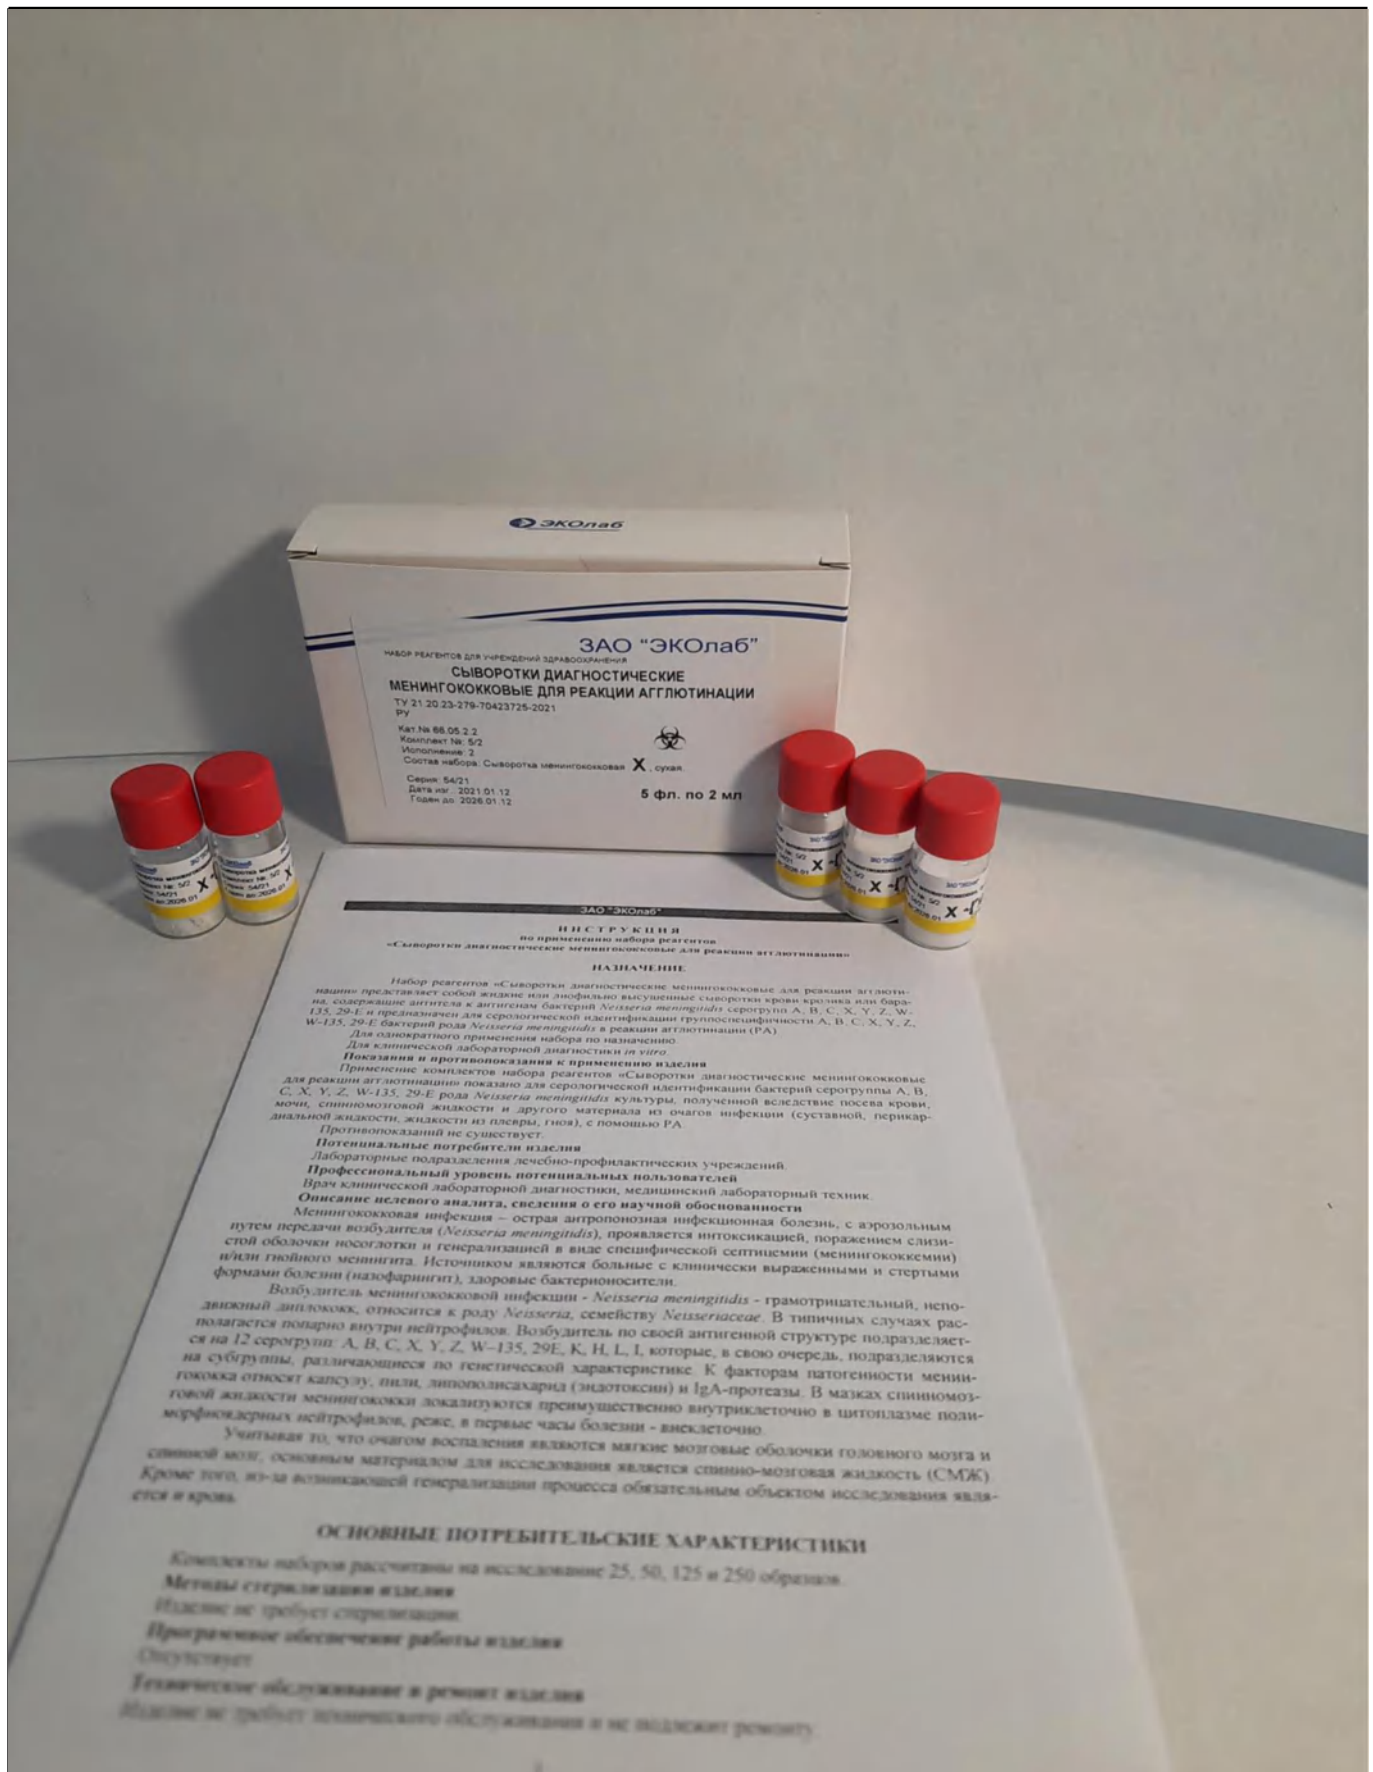


Комплект №5/3, Исполнение 2 Сыворотка менингококковая X, жидкая

серия 55/21 от 2021.01.12

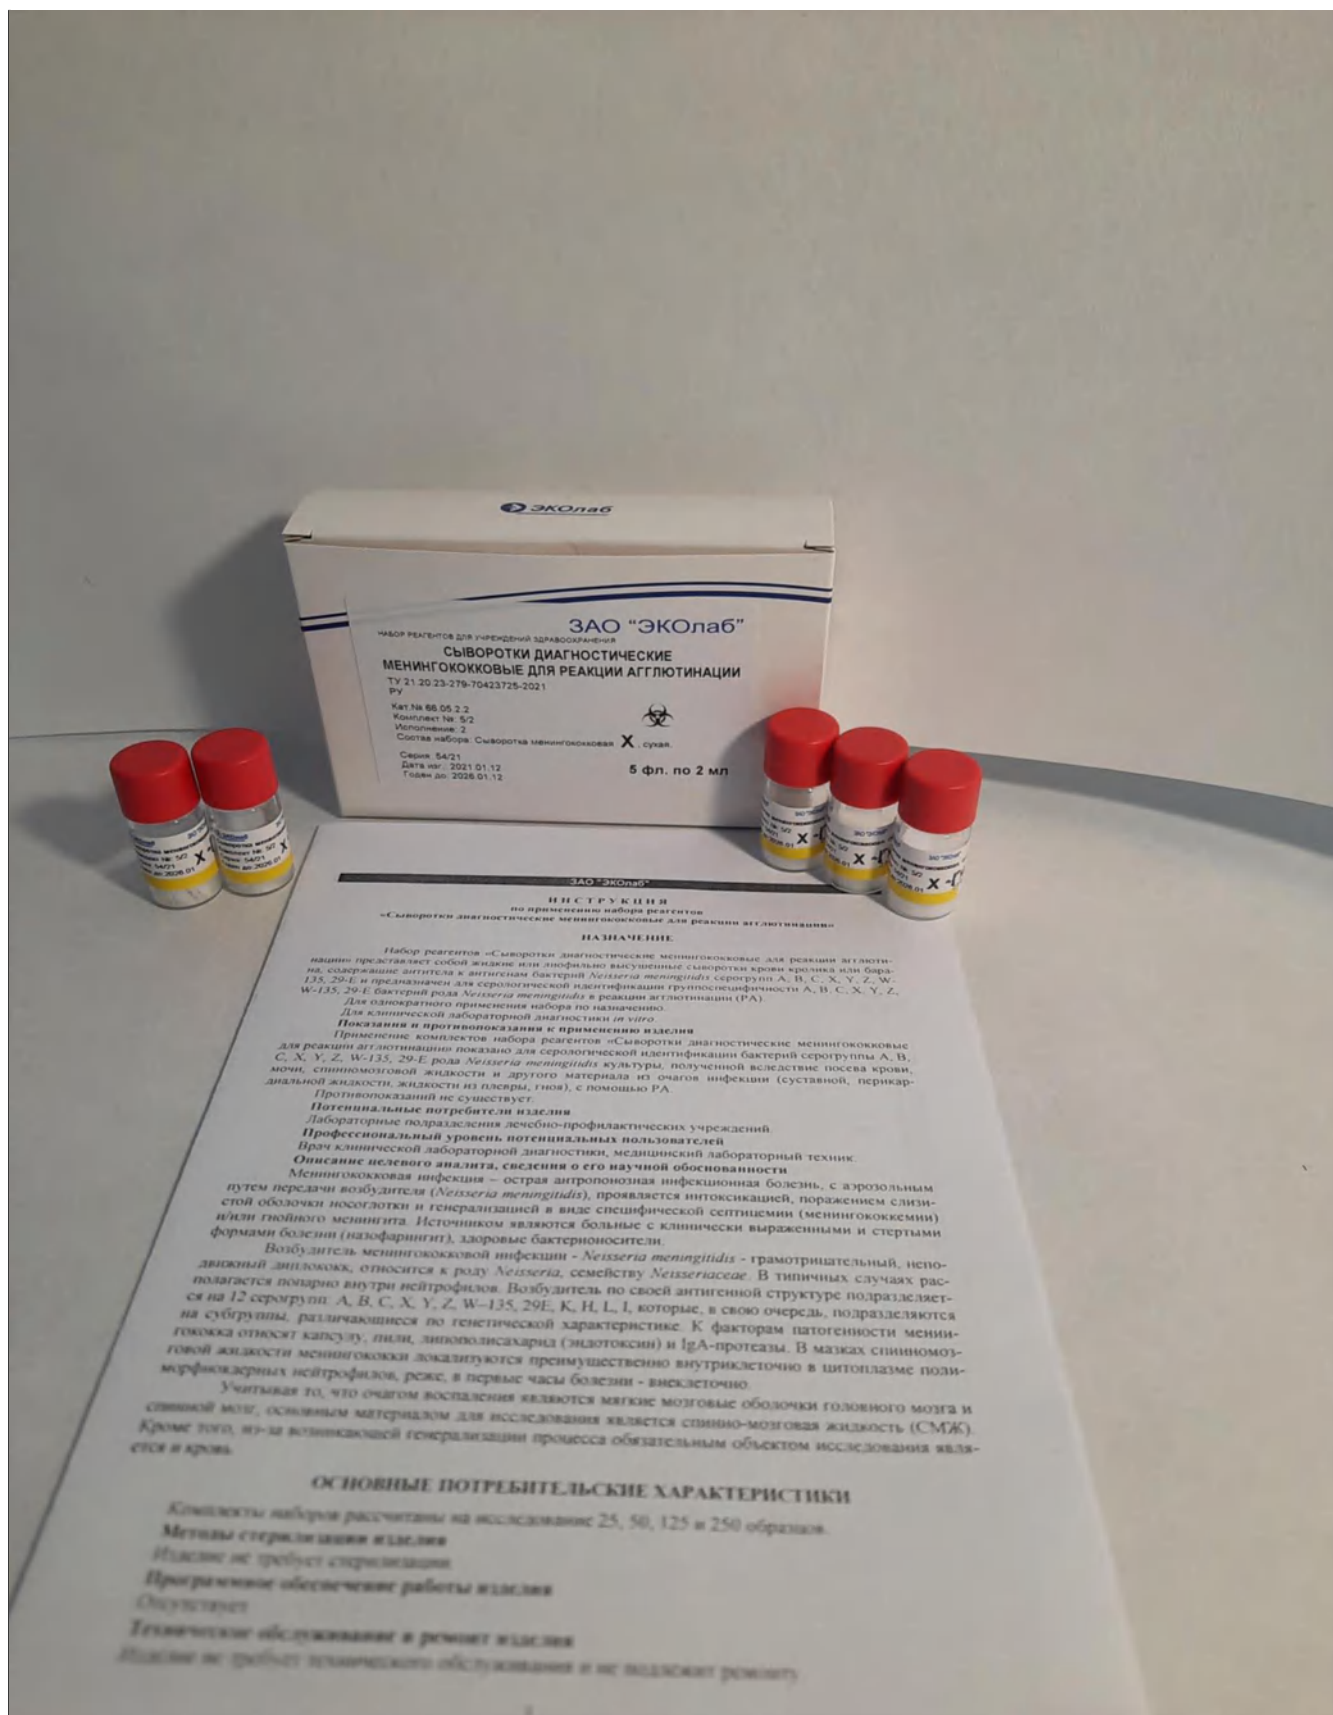


Комплект №5/4, Исполнение 2 Сыворотка менингококковая X, жидкая

серия 56/21 от 2021.01.12

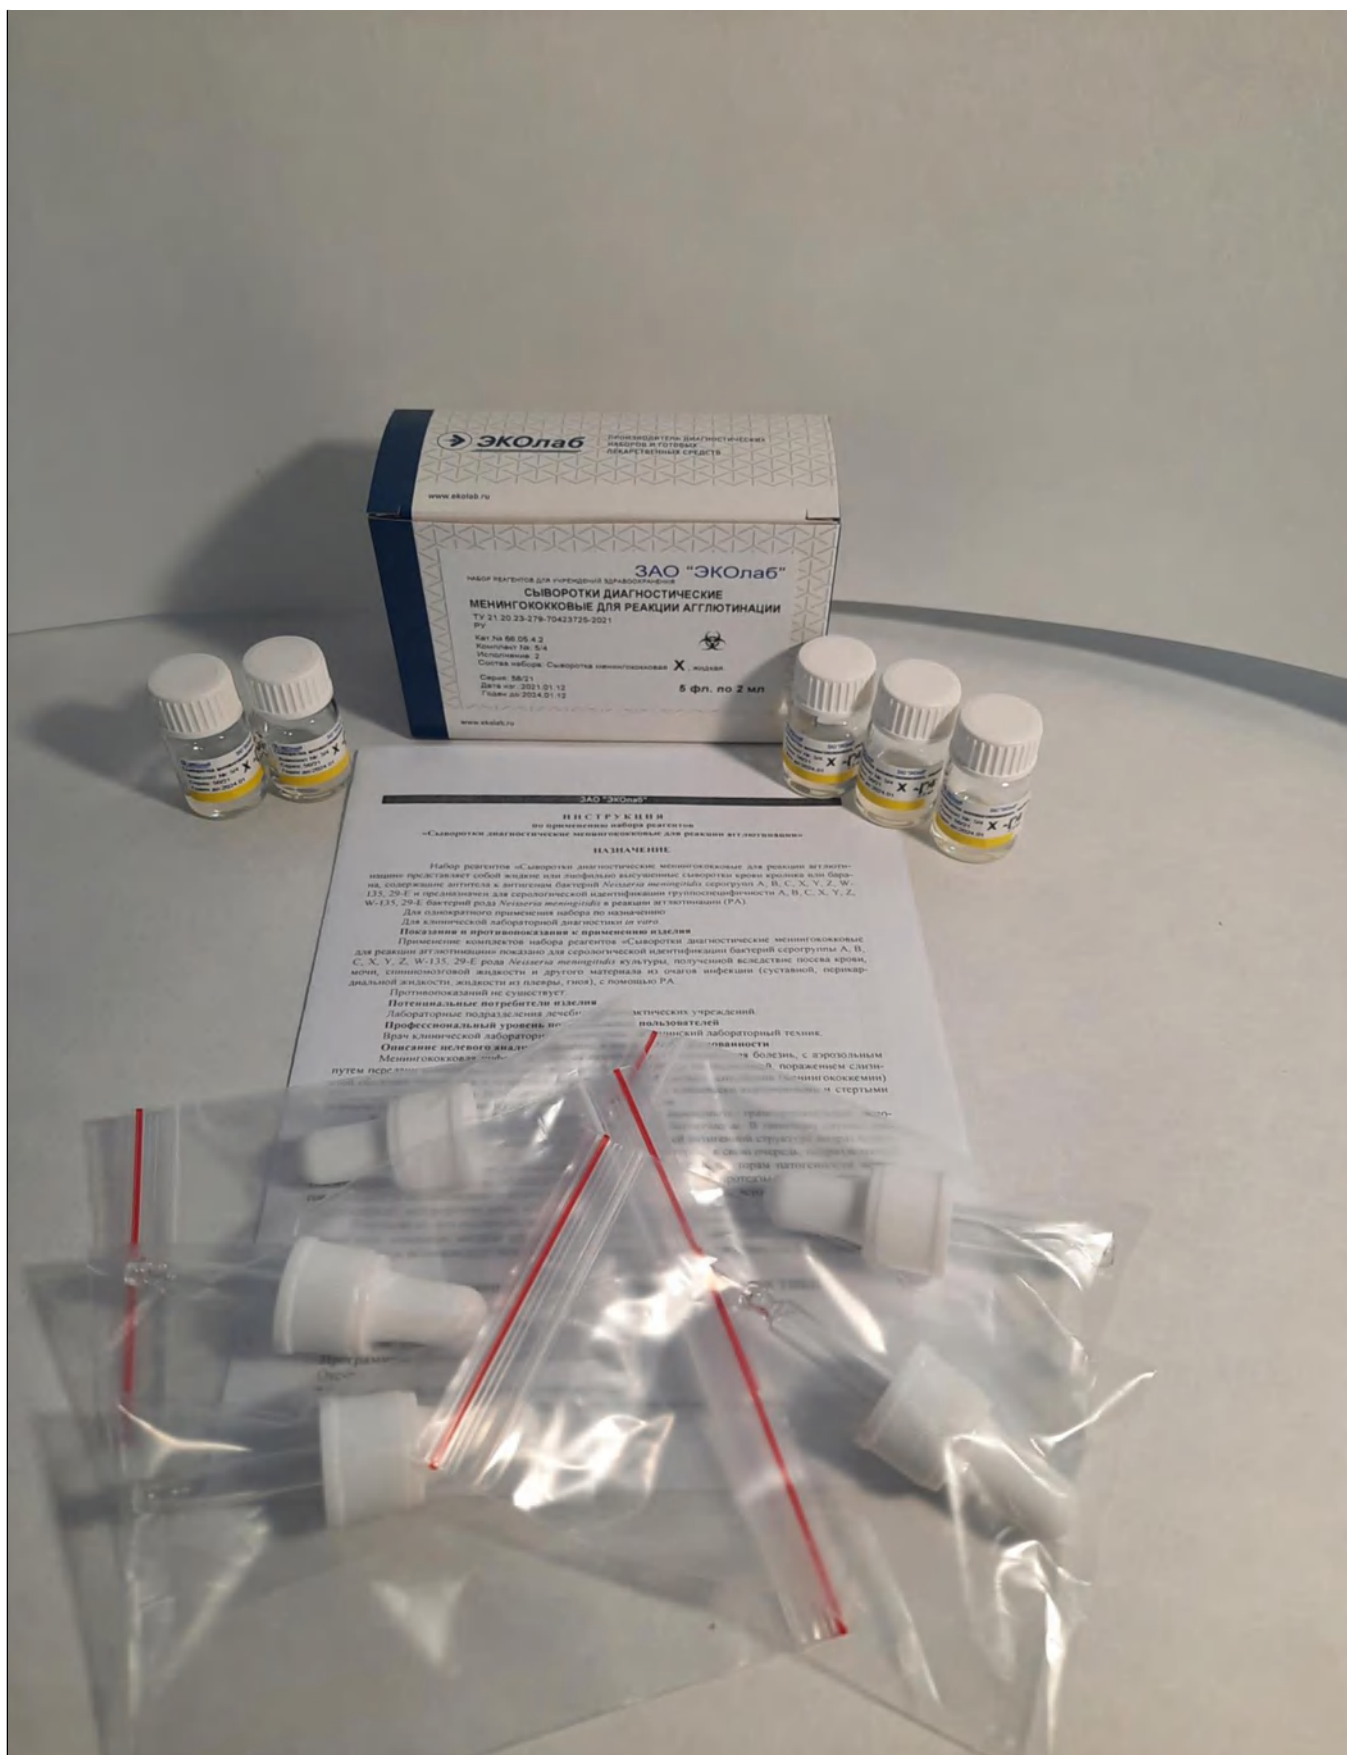


Комплект №6/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Y, сухая

серия 57/21 от 2021.01.12

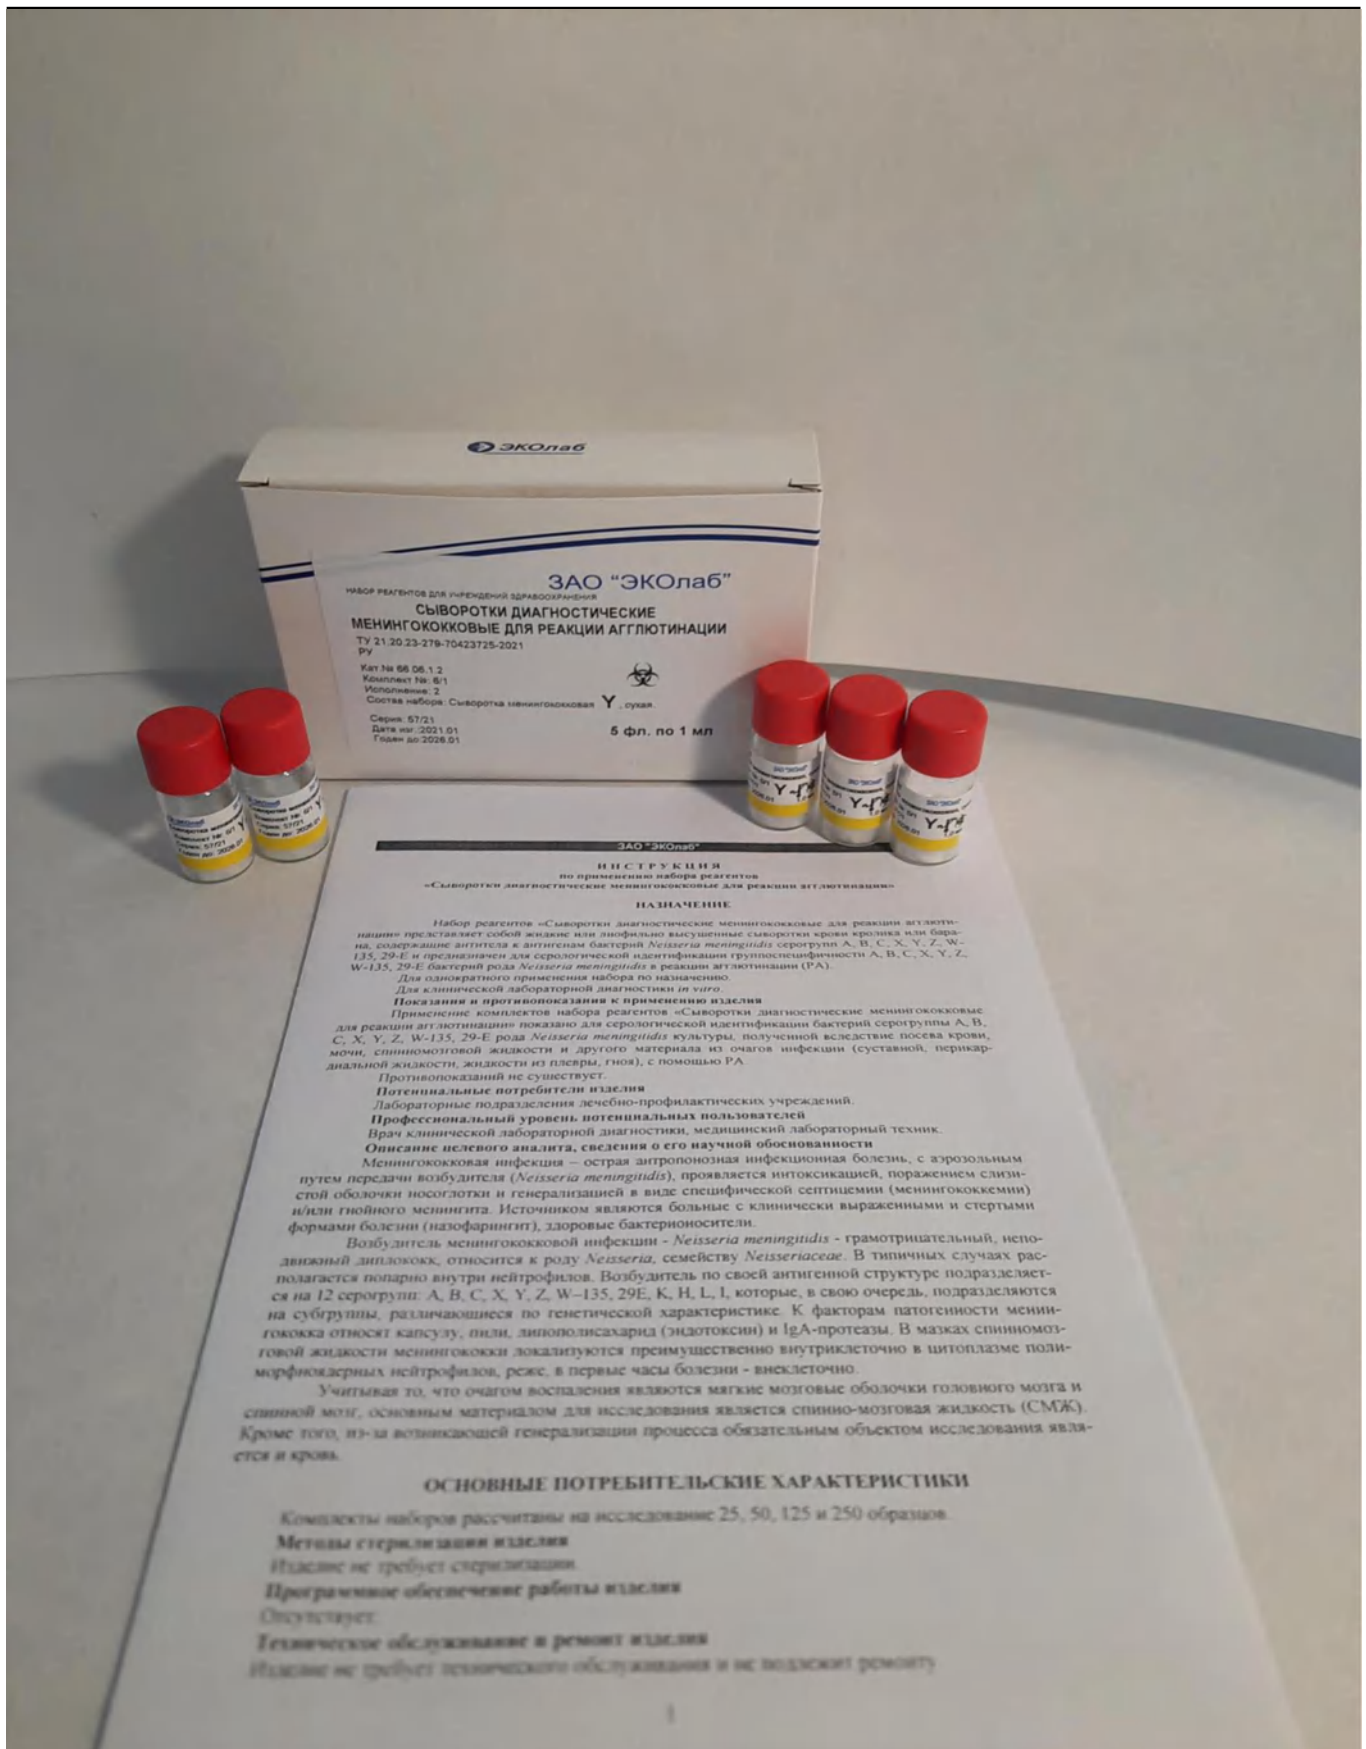


Комплект №6/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Y, сухая

серия 58/21 от 2021.01.12

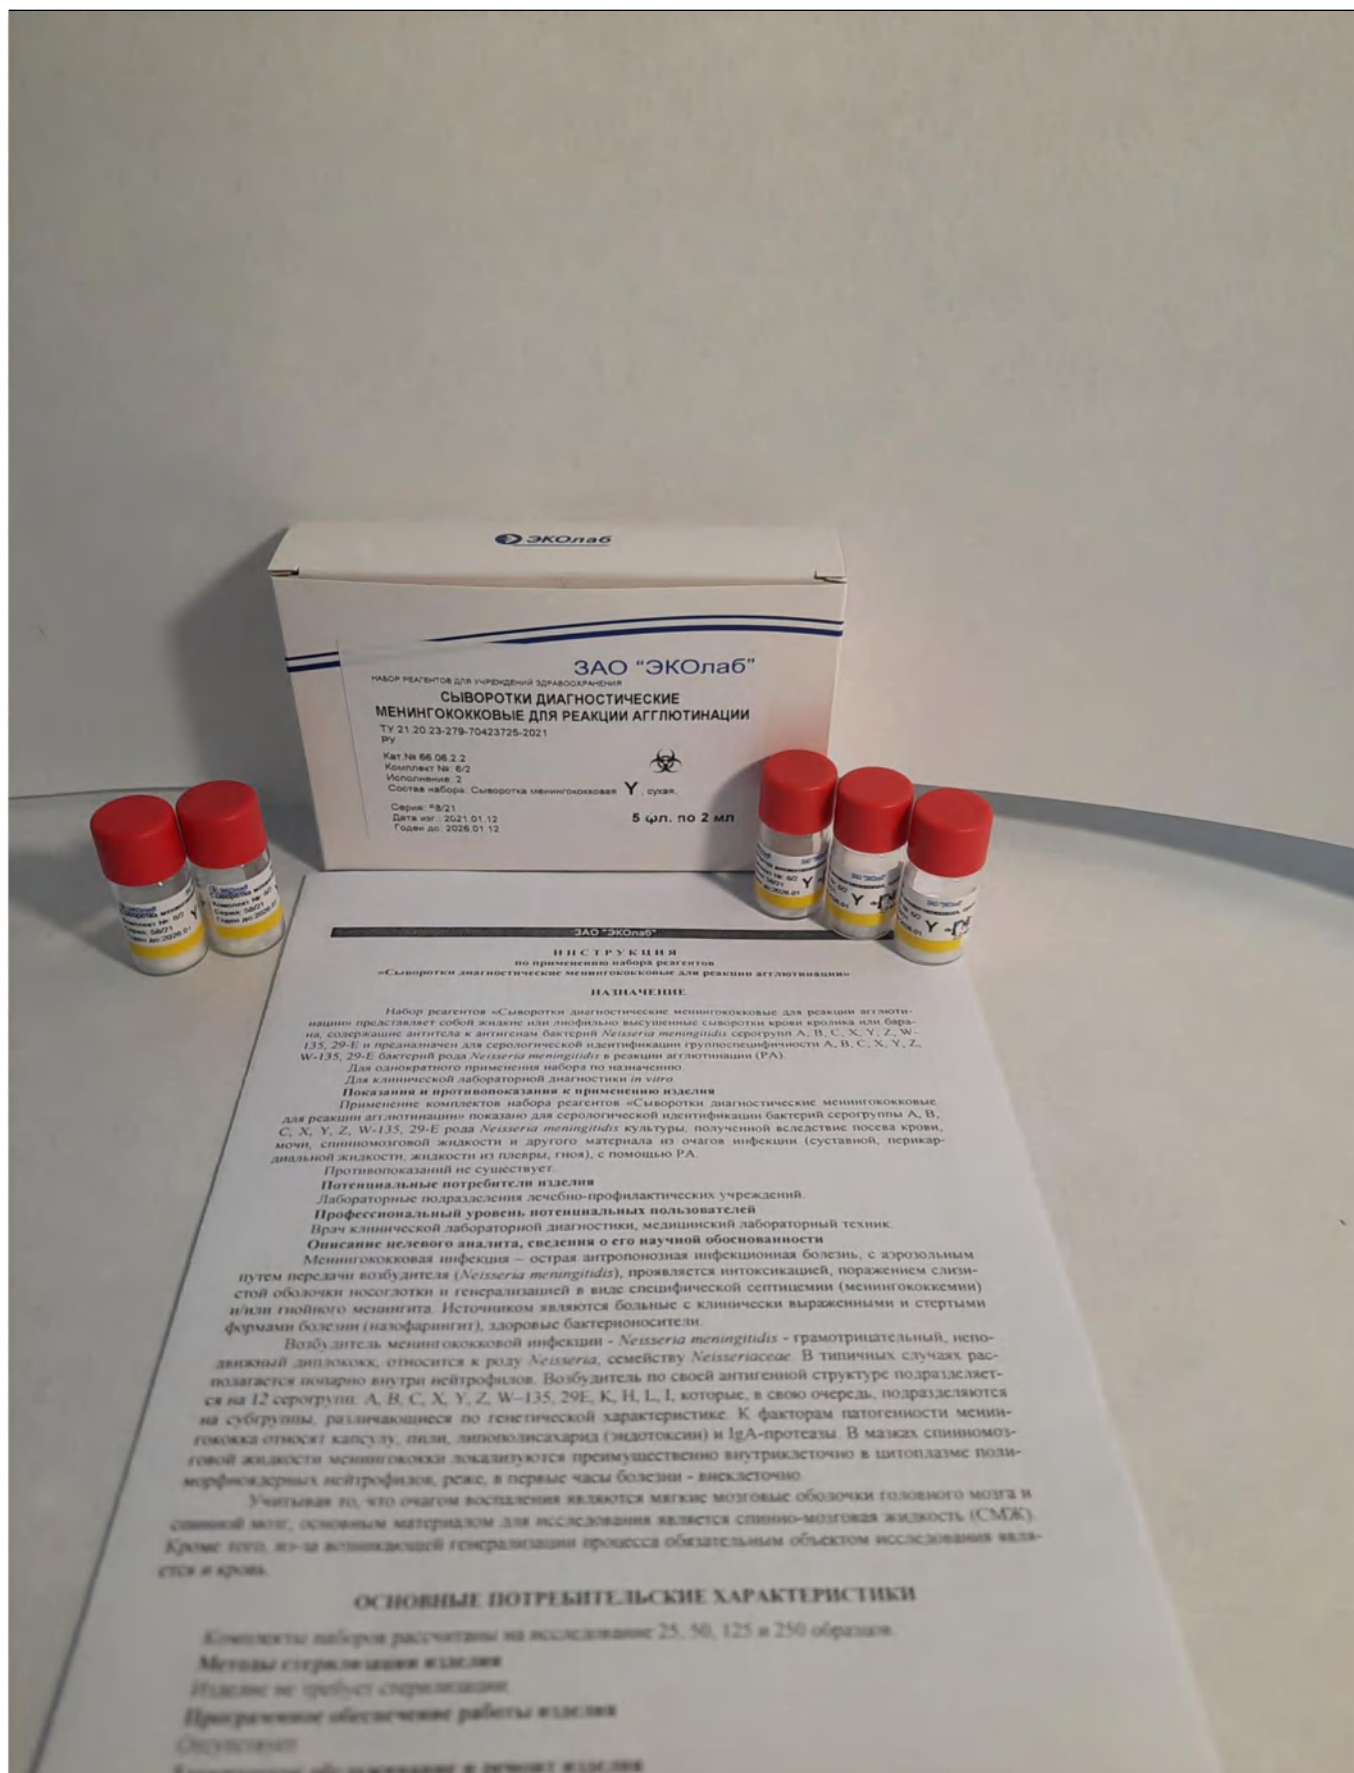


Комплект №6/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Y, жидкая

серия 59/21 от 2021.01.12

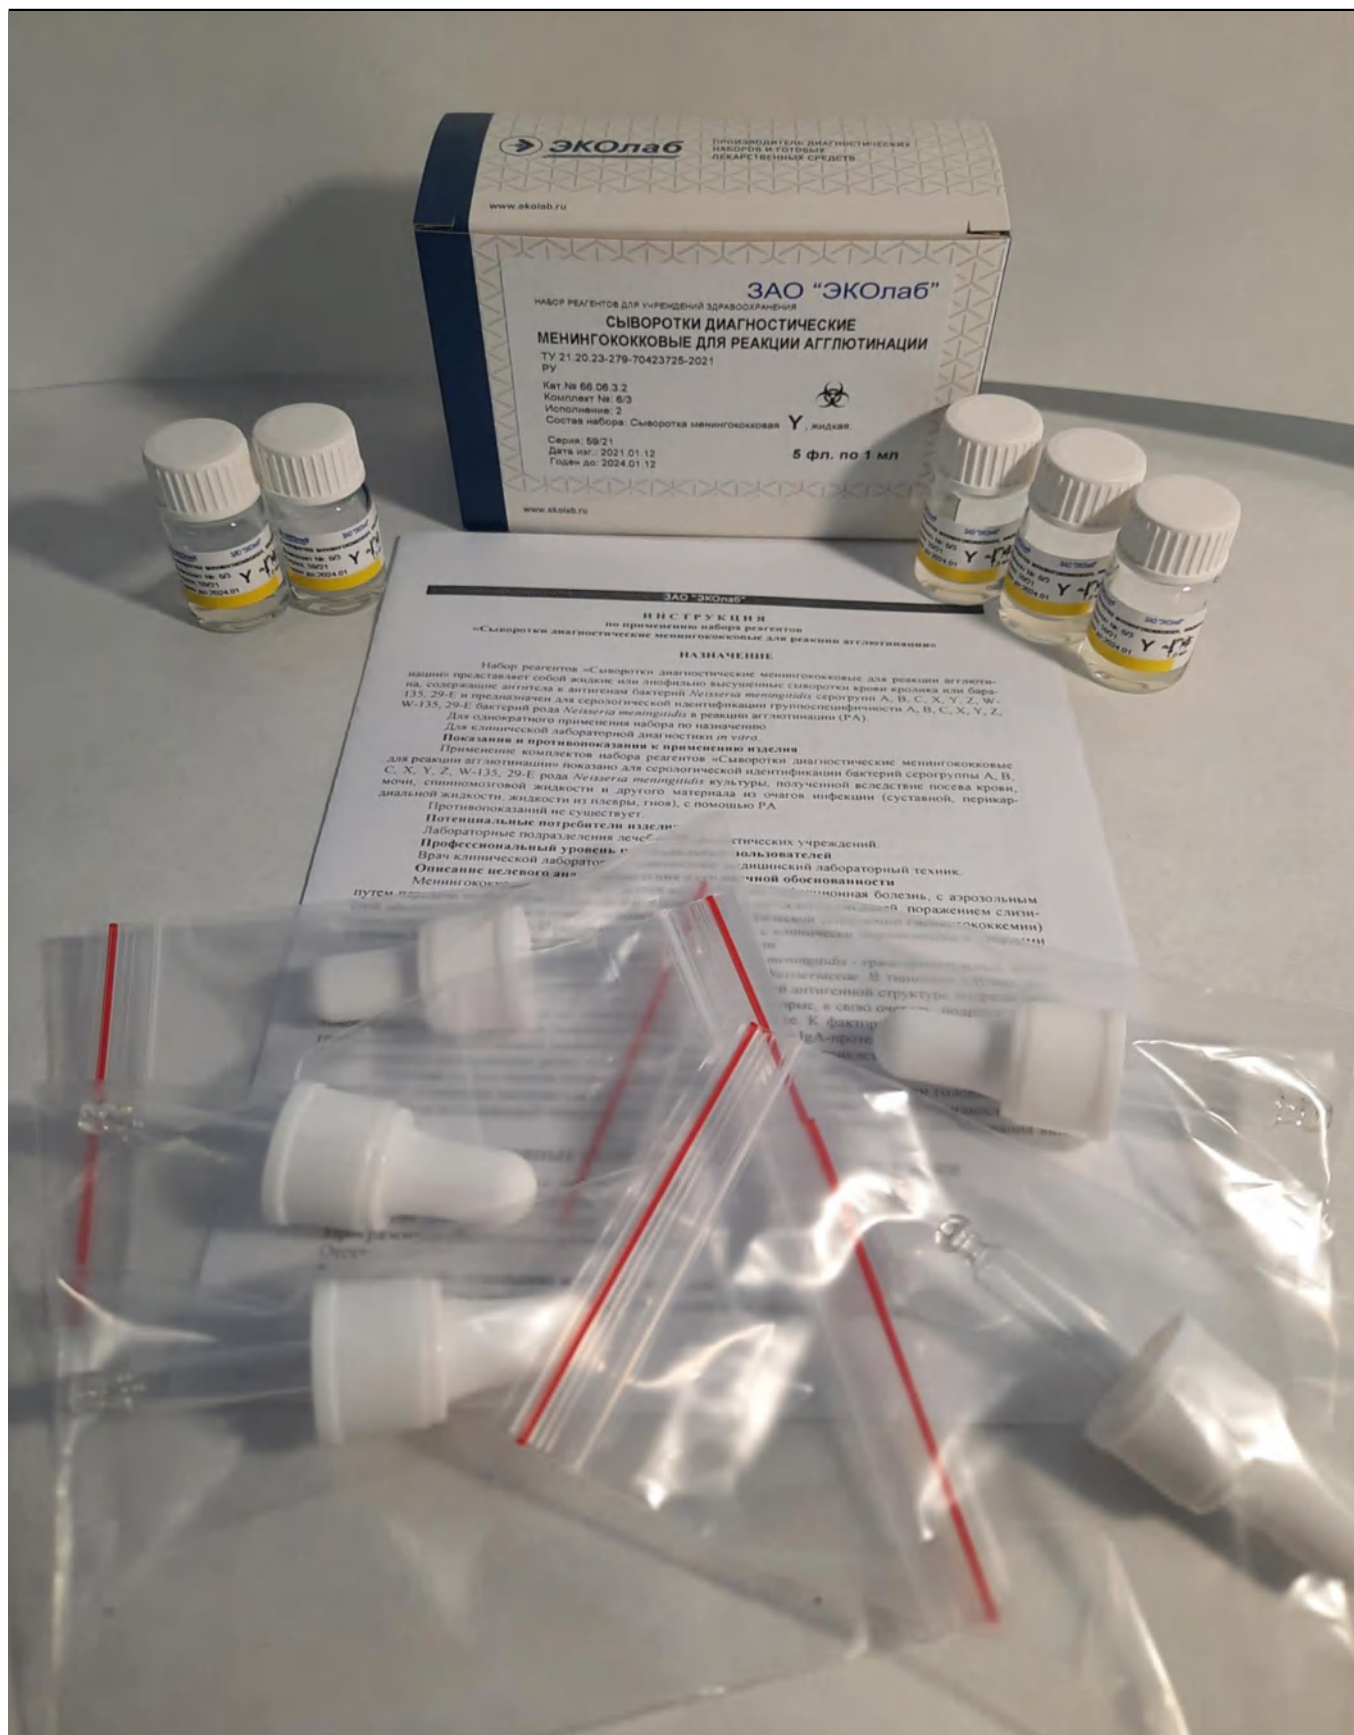


Комплект №6/4, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Y, жидкая

серия 60/21 от 2021.01.12

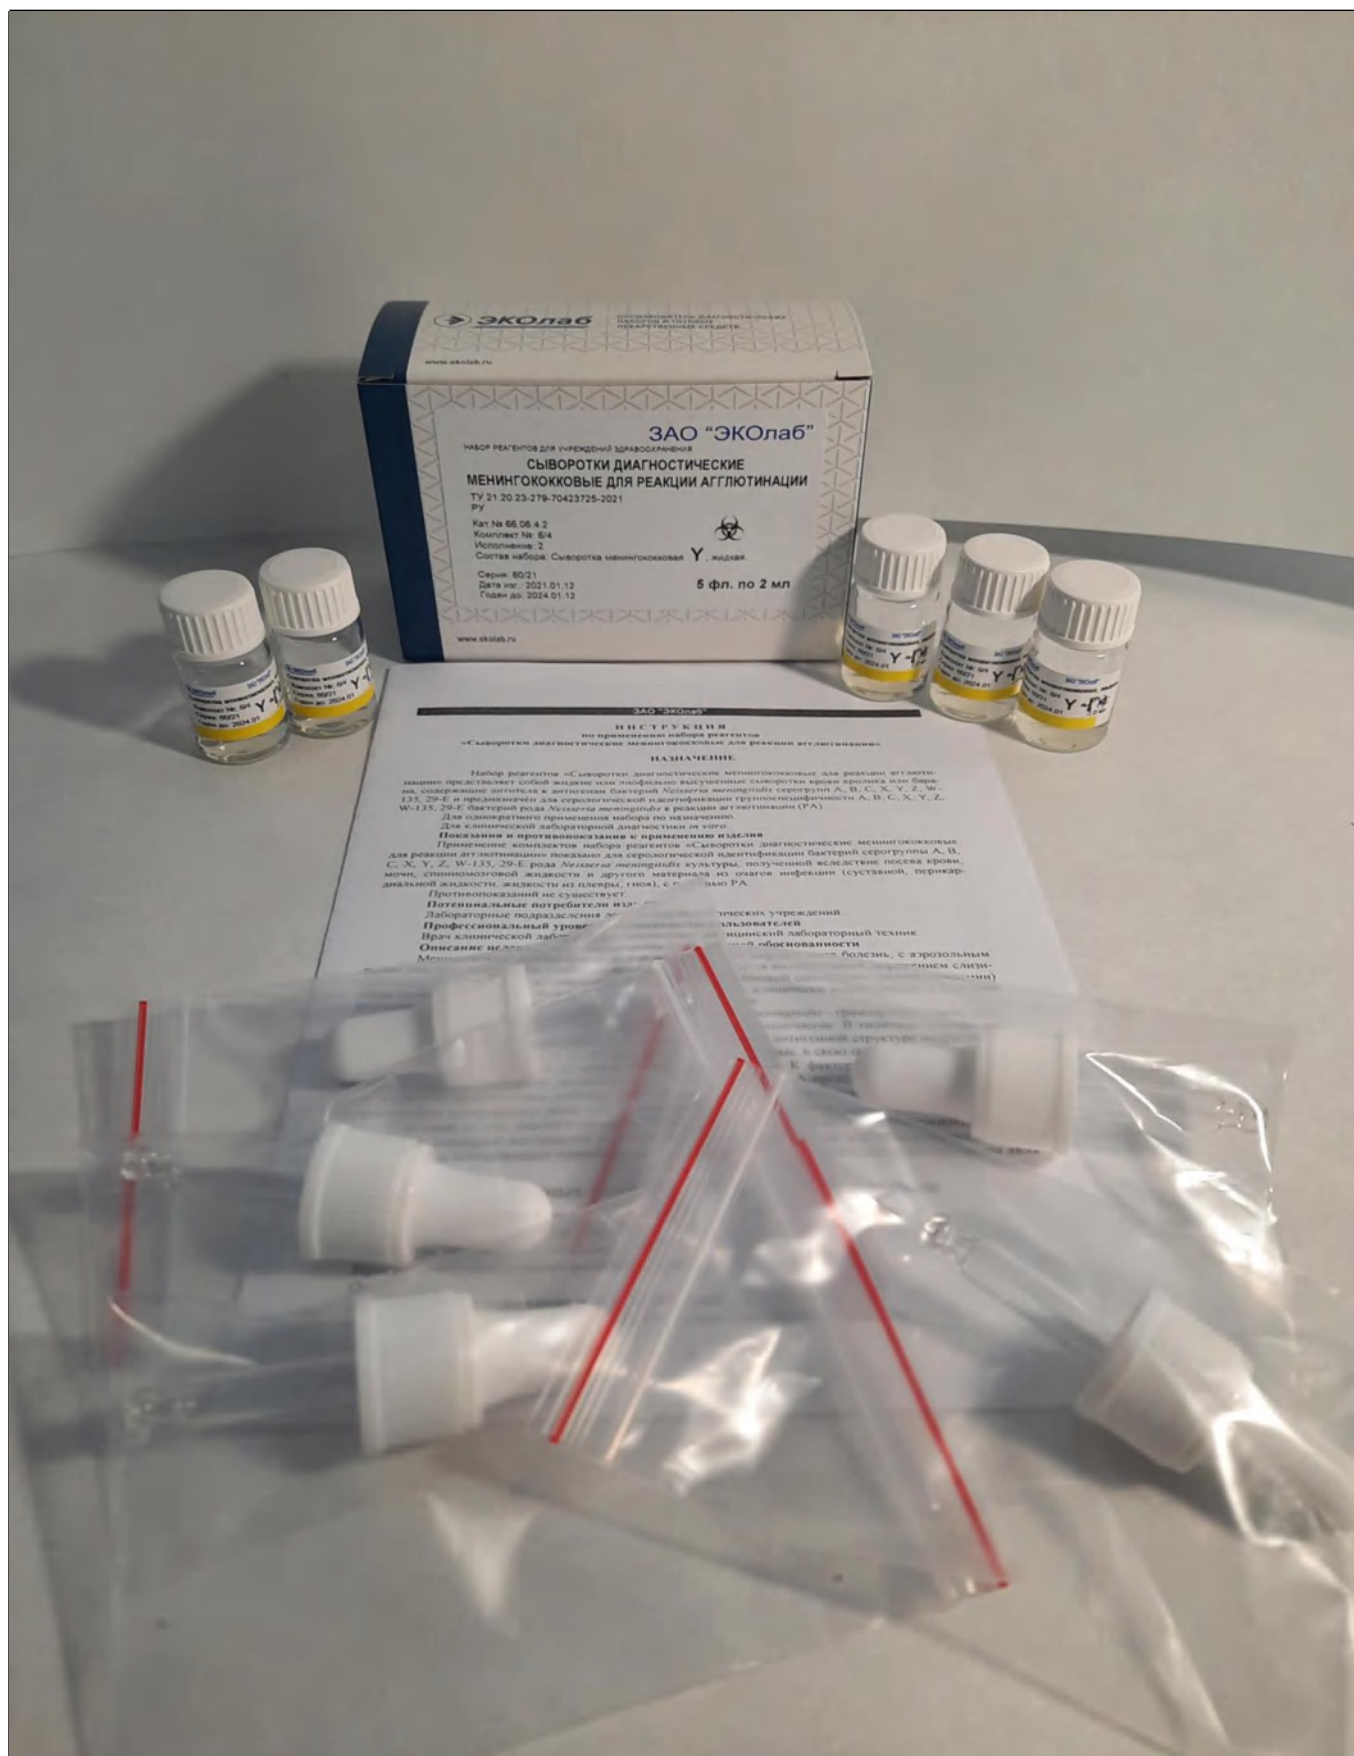


Комплект №7/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Z, сухая

серия 61/21 от 2021.01.12

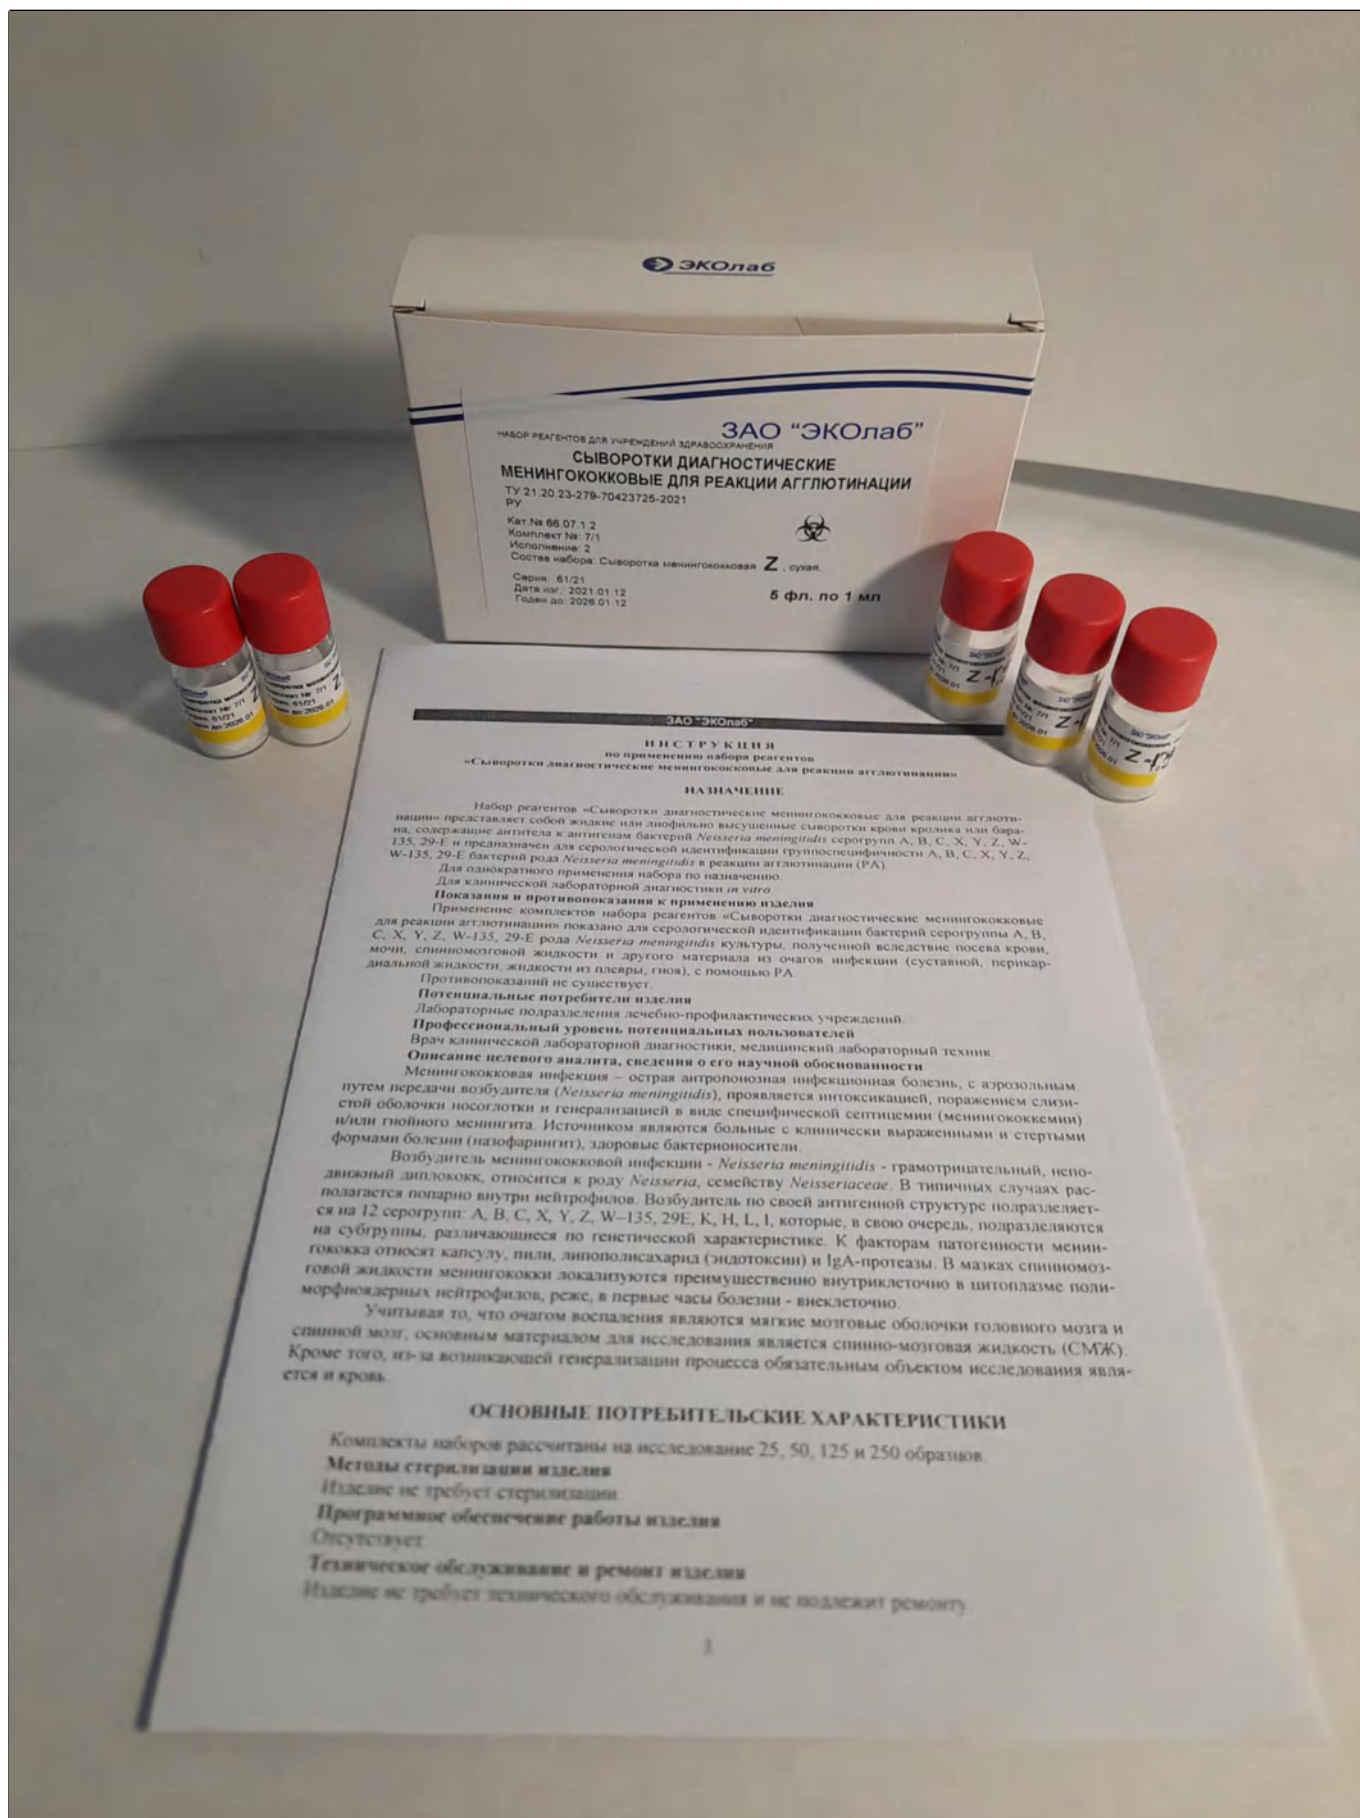

Комплект №7/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Z, сухая
серия 62/21 от 2021.01.12

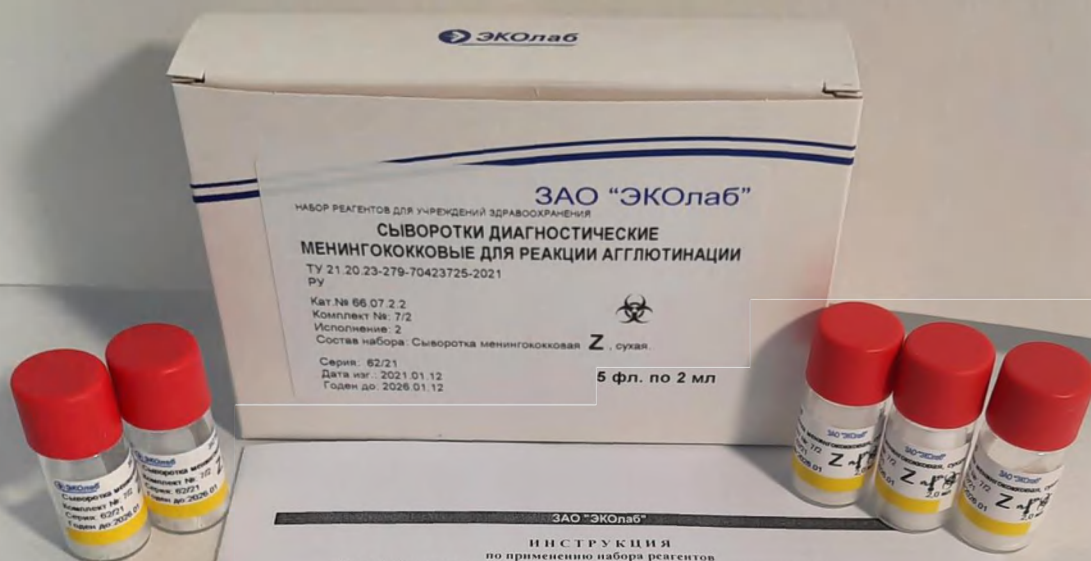

ЗАО "ЭКОлаб"
ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»
НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к антигенам бактерий *Neisseria meningitidis* серогрупп А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E и предназначен для серологической идентификации группоспецифичности А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E бактерий рода *Neisseria meningitidis* в реакции агглютинации (РА).
Для однократного применения набора по назначению.
Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Показания и противопоказания к применению изделия

Применение комплектов набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E рода *Neisseria meningitidis* культуры, полученной вследствие посева крови, мочи, спинномозговой жидкости и другого материала из очагов инфекции (суставной, перикардиальной жидкости, жидкости из плевры, гноя), с помощью РА.
Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности

Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (*Neisseria meningitidis*), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококкемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными и стертыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции – *Neisseria meningitidis* – грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду *Neisseria*, семейству *Neisseriaceae*. В типичных случаях располагается парно внутри нейтрофилов. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29E, K, H, L, I, которые, в свою очередь, подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К факторам патогенности менингококка относят капсулу, пили, липополисахарид (эндотоксин) и IgA-протеазы. В мазках спинномозговой жидкости менингококки локализуются преимущественно внутриклеточно в цитоплазме полиморфноядерных нейтрофилов, реже, в первые часы болезни – внеклеточно.

Учитывая то, что очагом воспаления являются мягкие мозговые оболочки головного мозга и спинной мозг, основным материалом для исследования является спинно-мозговая жидкость (СМЖ). Кроме того, из-за возникающей генерализации процесса обязательным объектом исследования является и кровь.


ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекты наборов рассчитаны на исследование 25, 50, 125 и 250 образцов.

Методы стабилизации и хранения


Комплект №7/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Z, жидкая

серия 63/21 от 2021.01.12

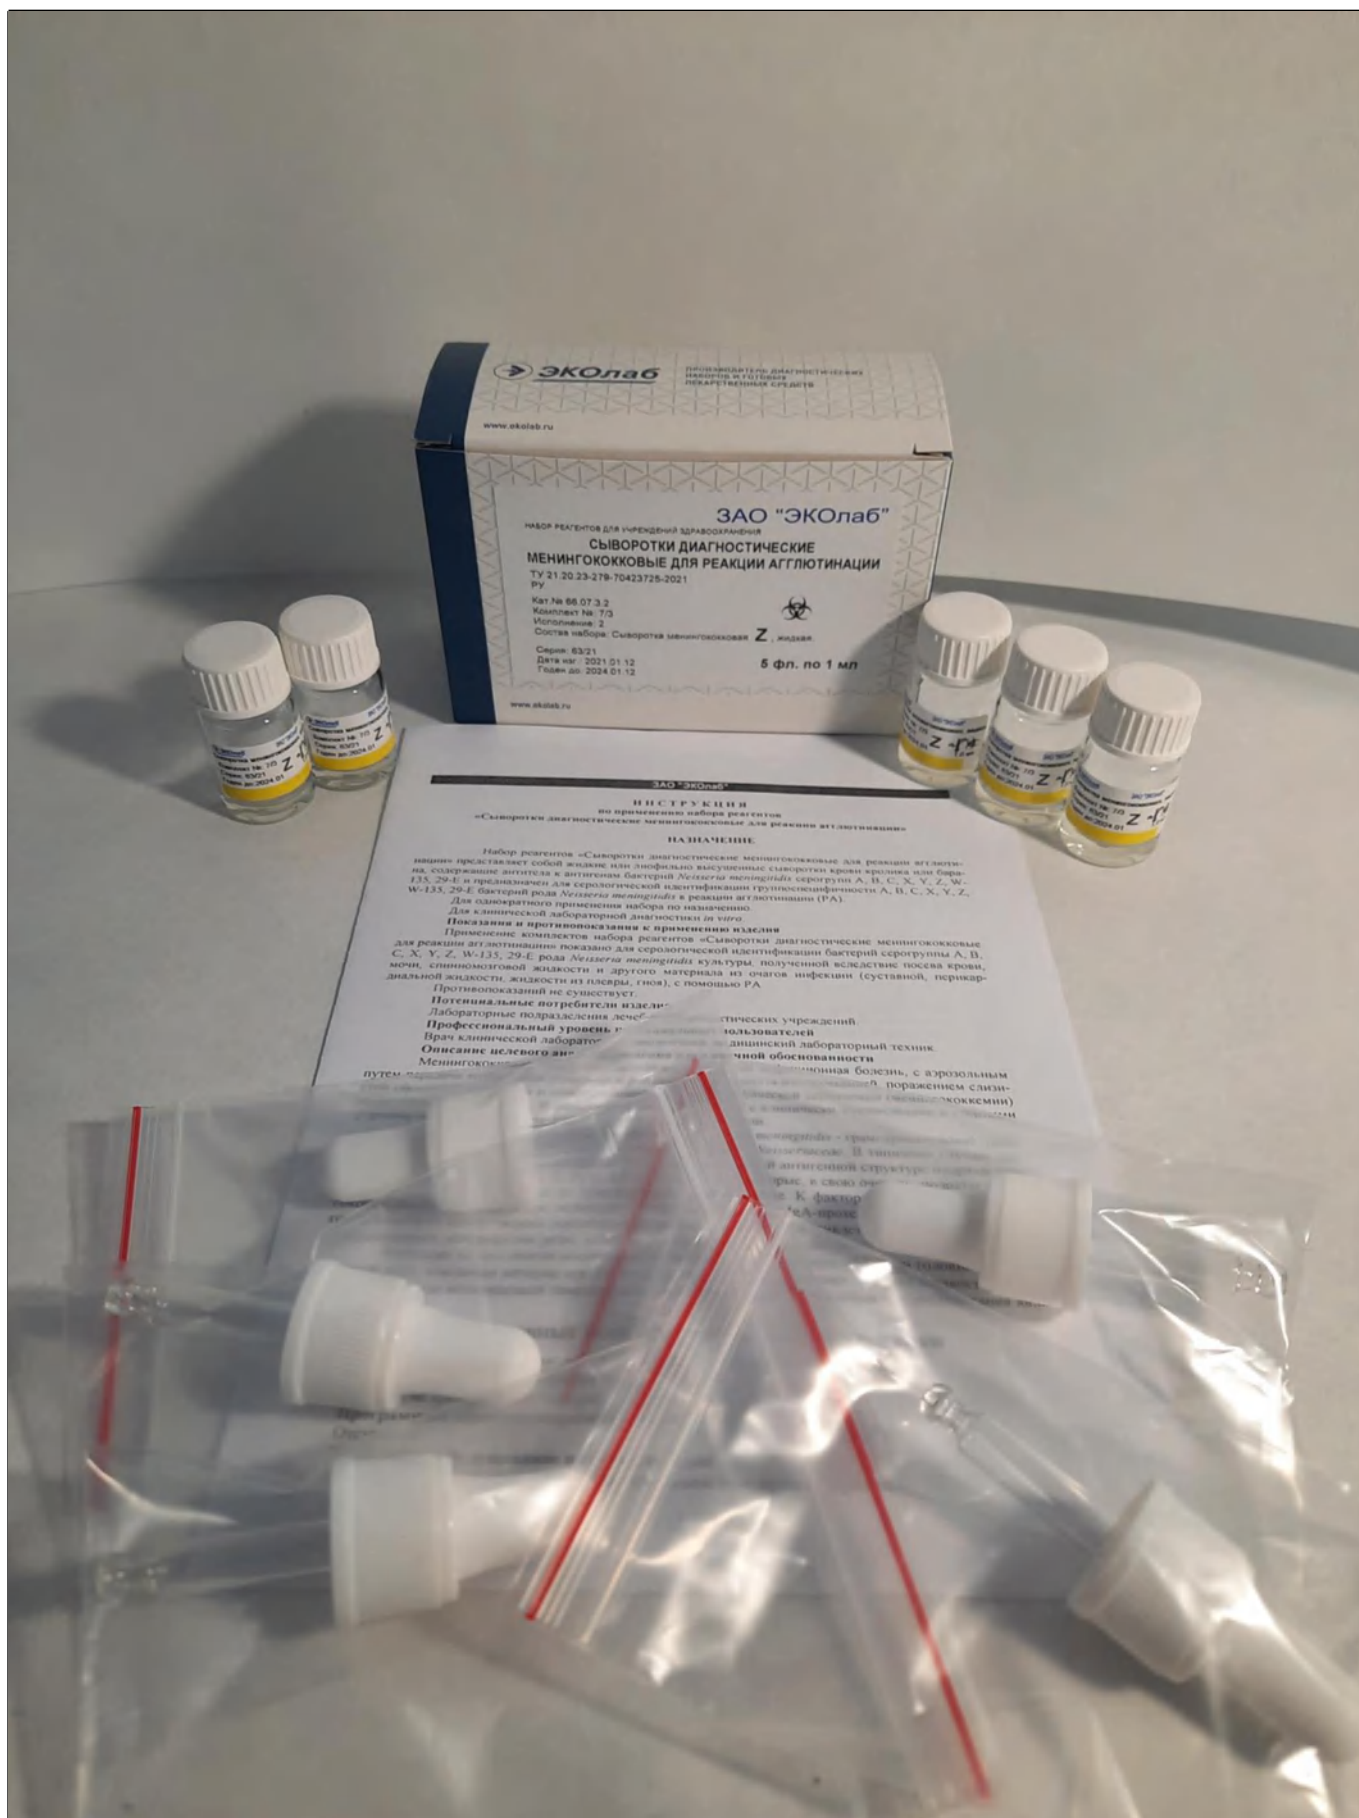


Комплект №7/4, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая Z, жидкая

серия 64/21 от 2021.01.12

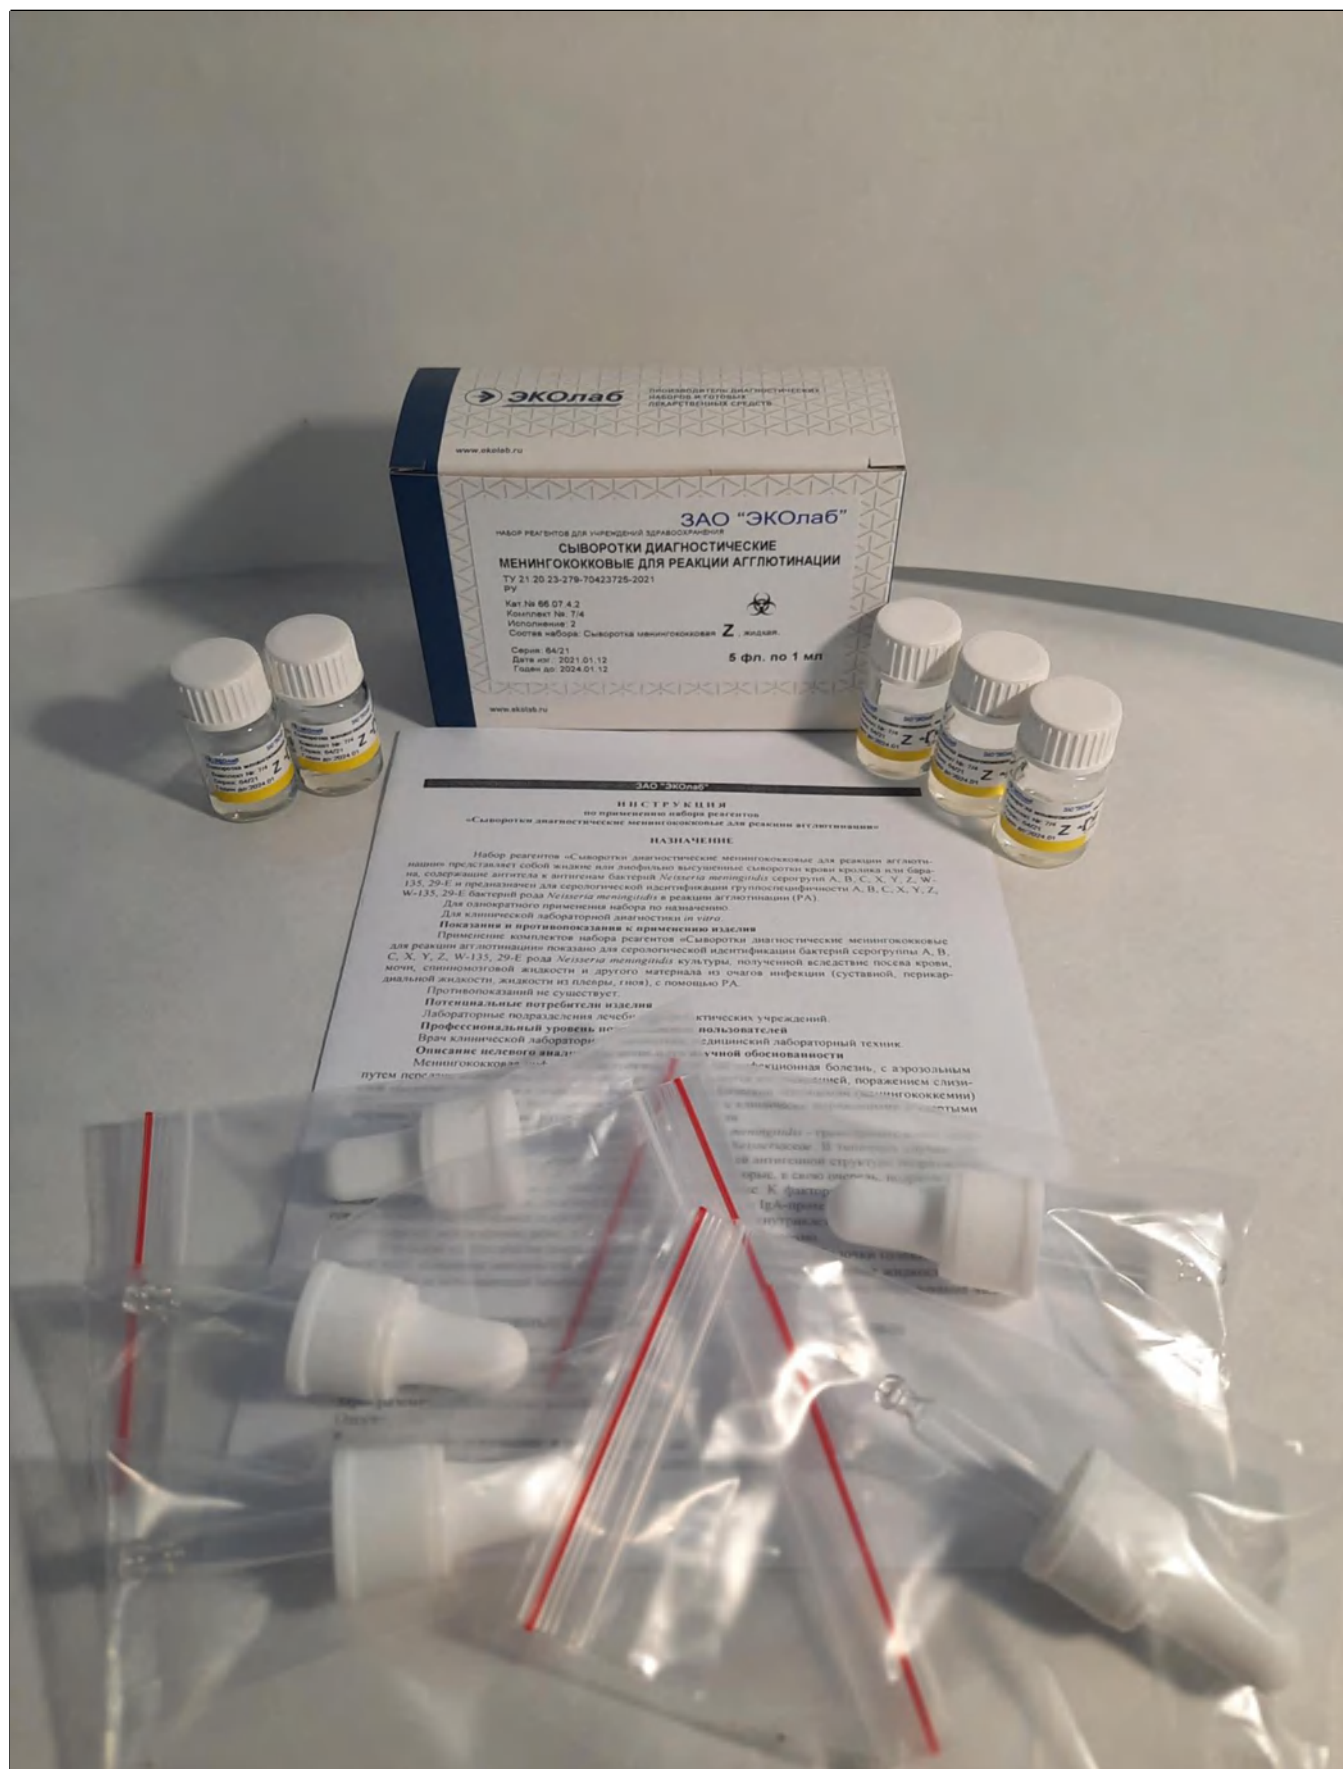


Комплект №8/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая W-135, сухая

серия 65/21 от 2021.01.12

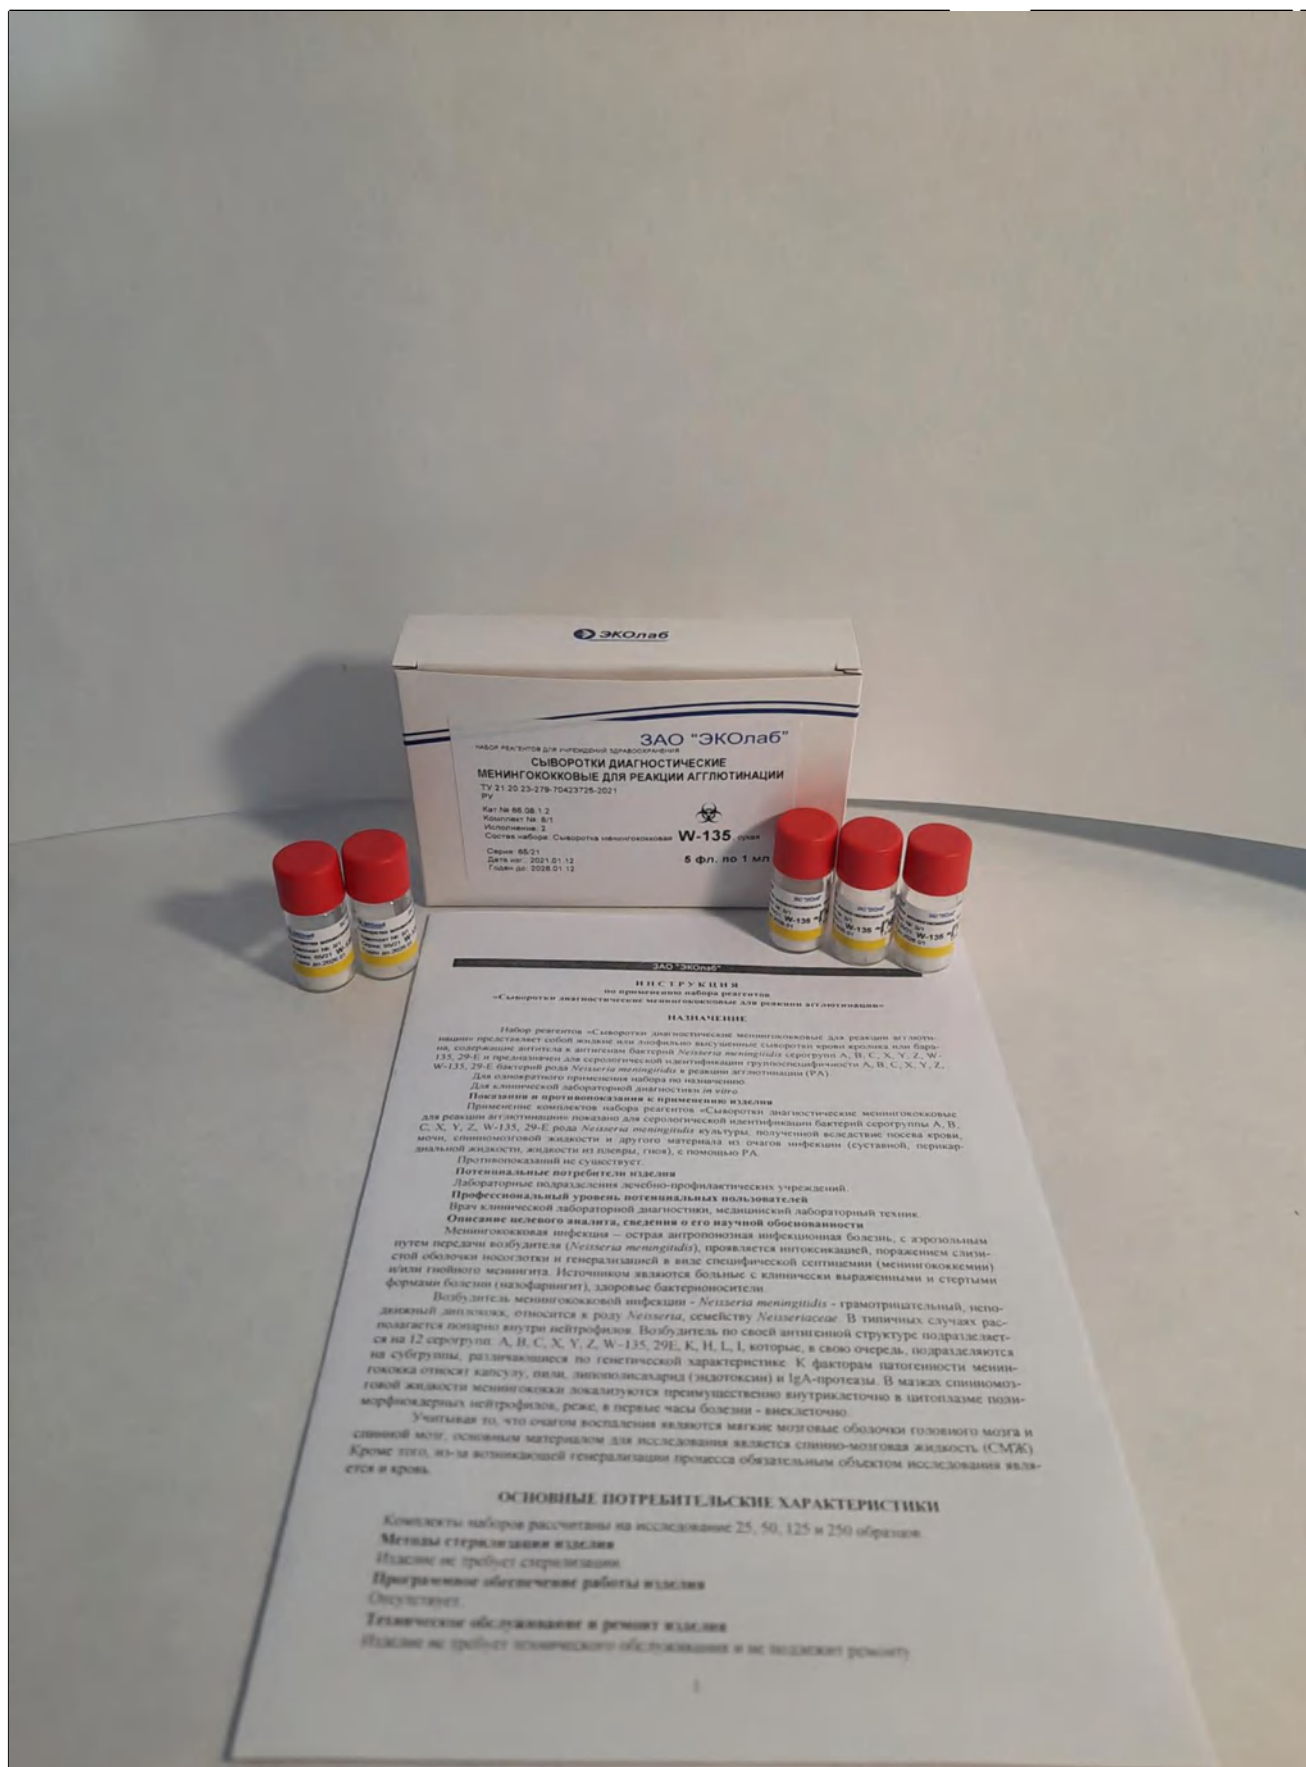


Комплект №8/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая W-135, сухая

серия 66/21 от 2021.01.12

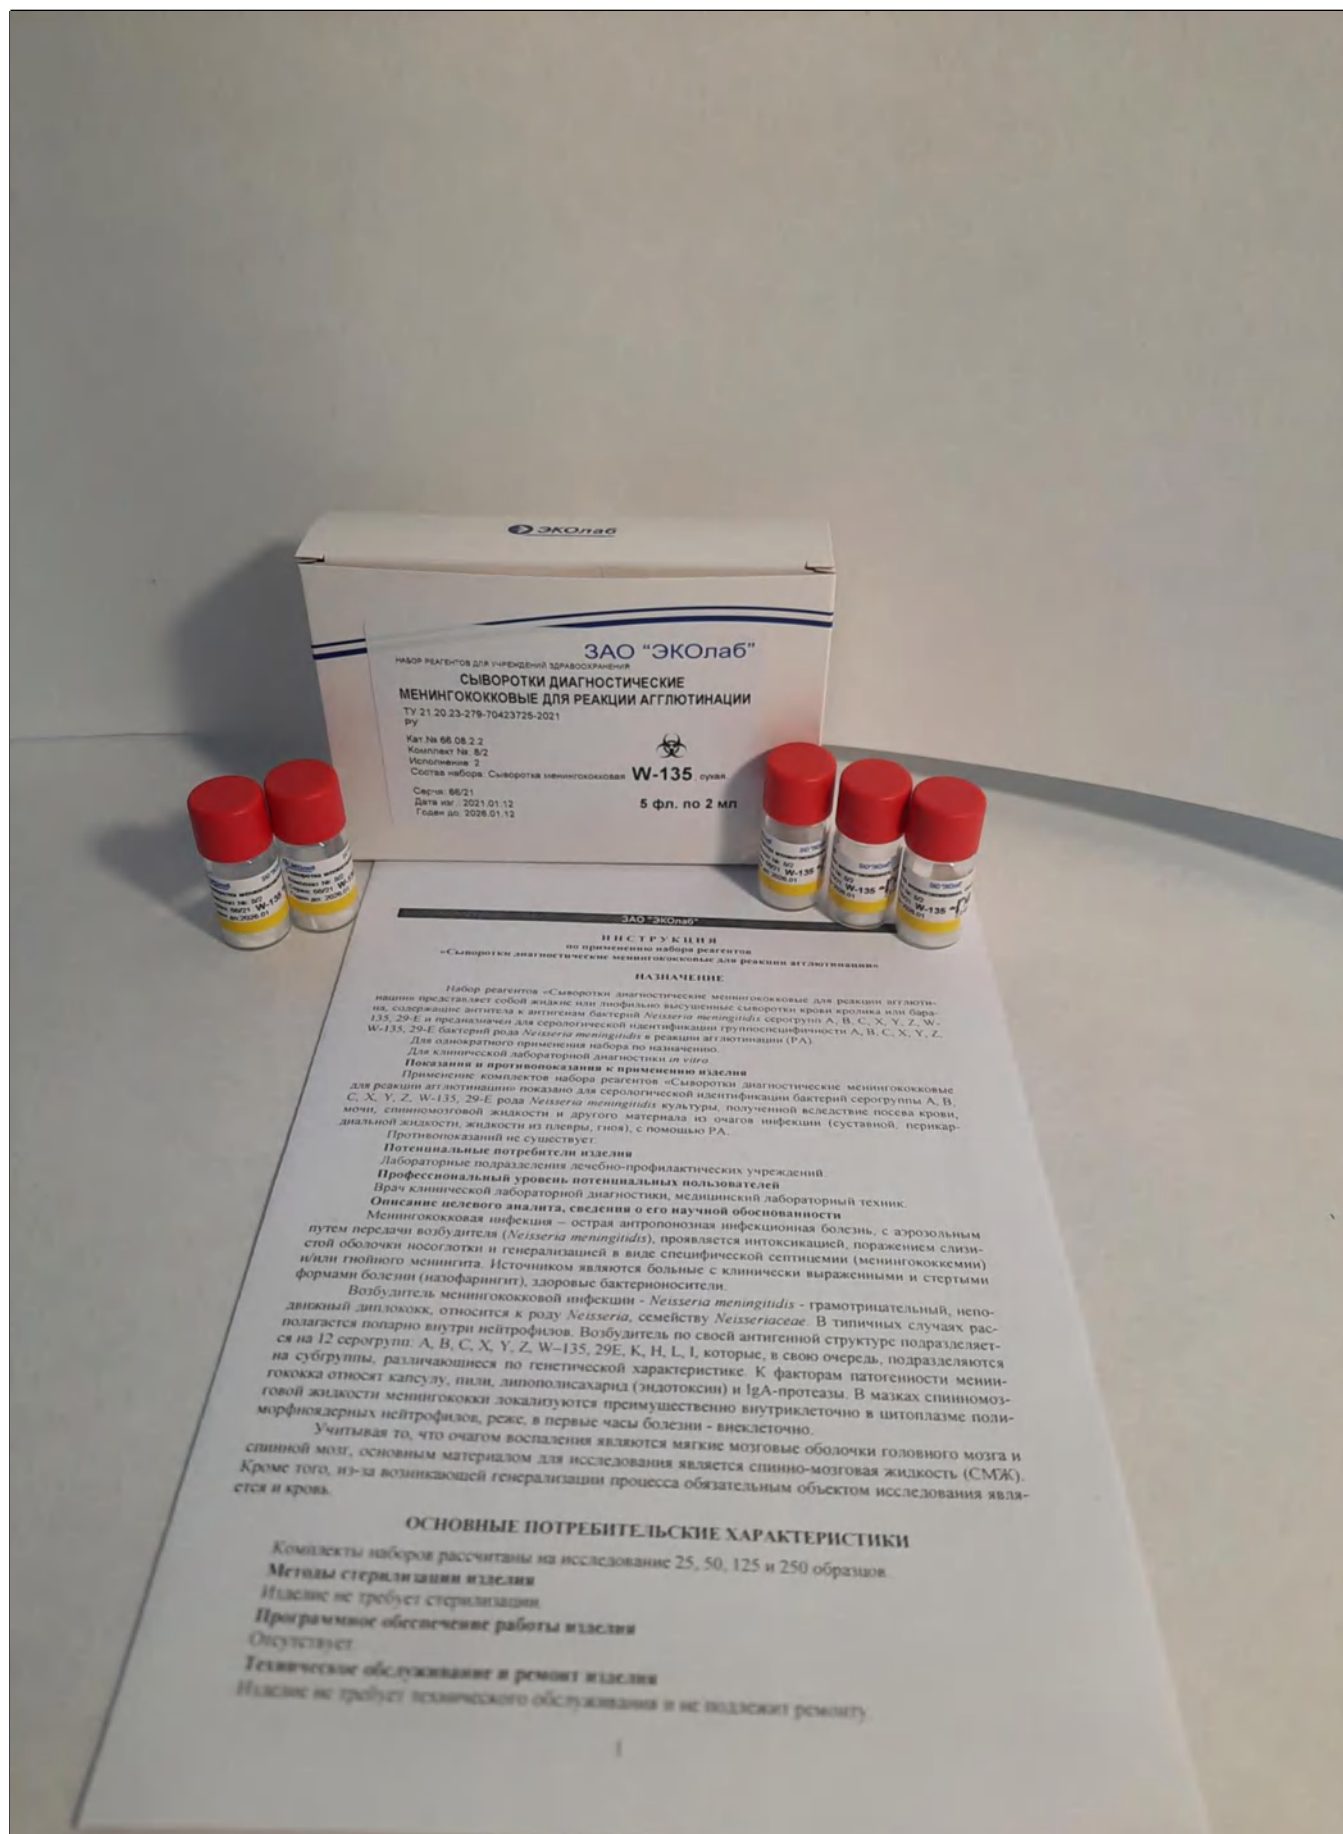


Комплект №8/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая W-135, жидкая


серия 67/21 от 2021.01.12

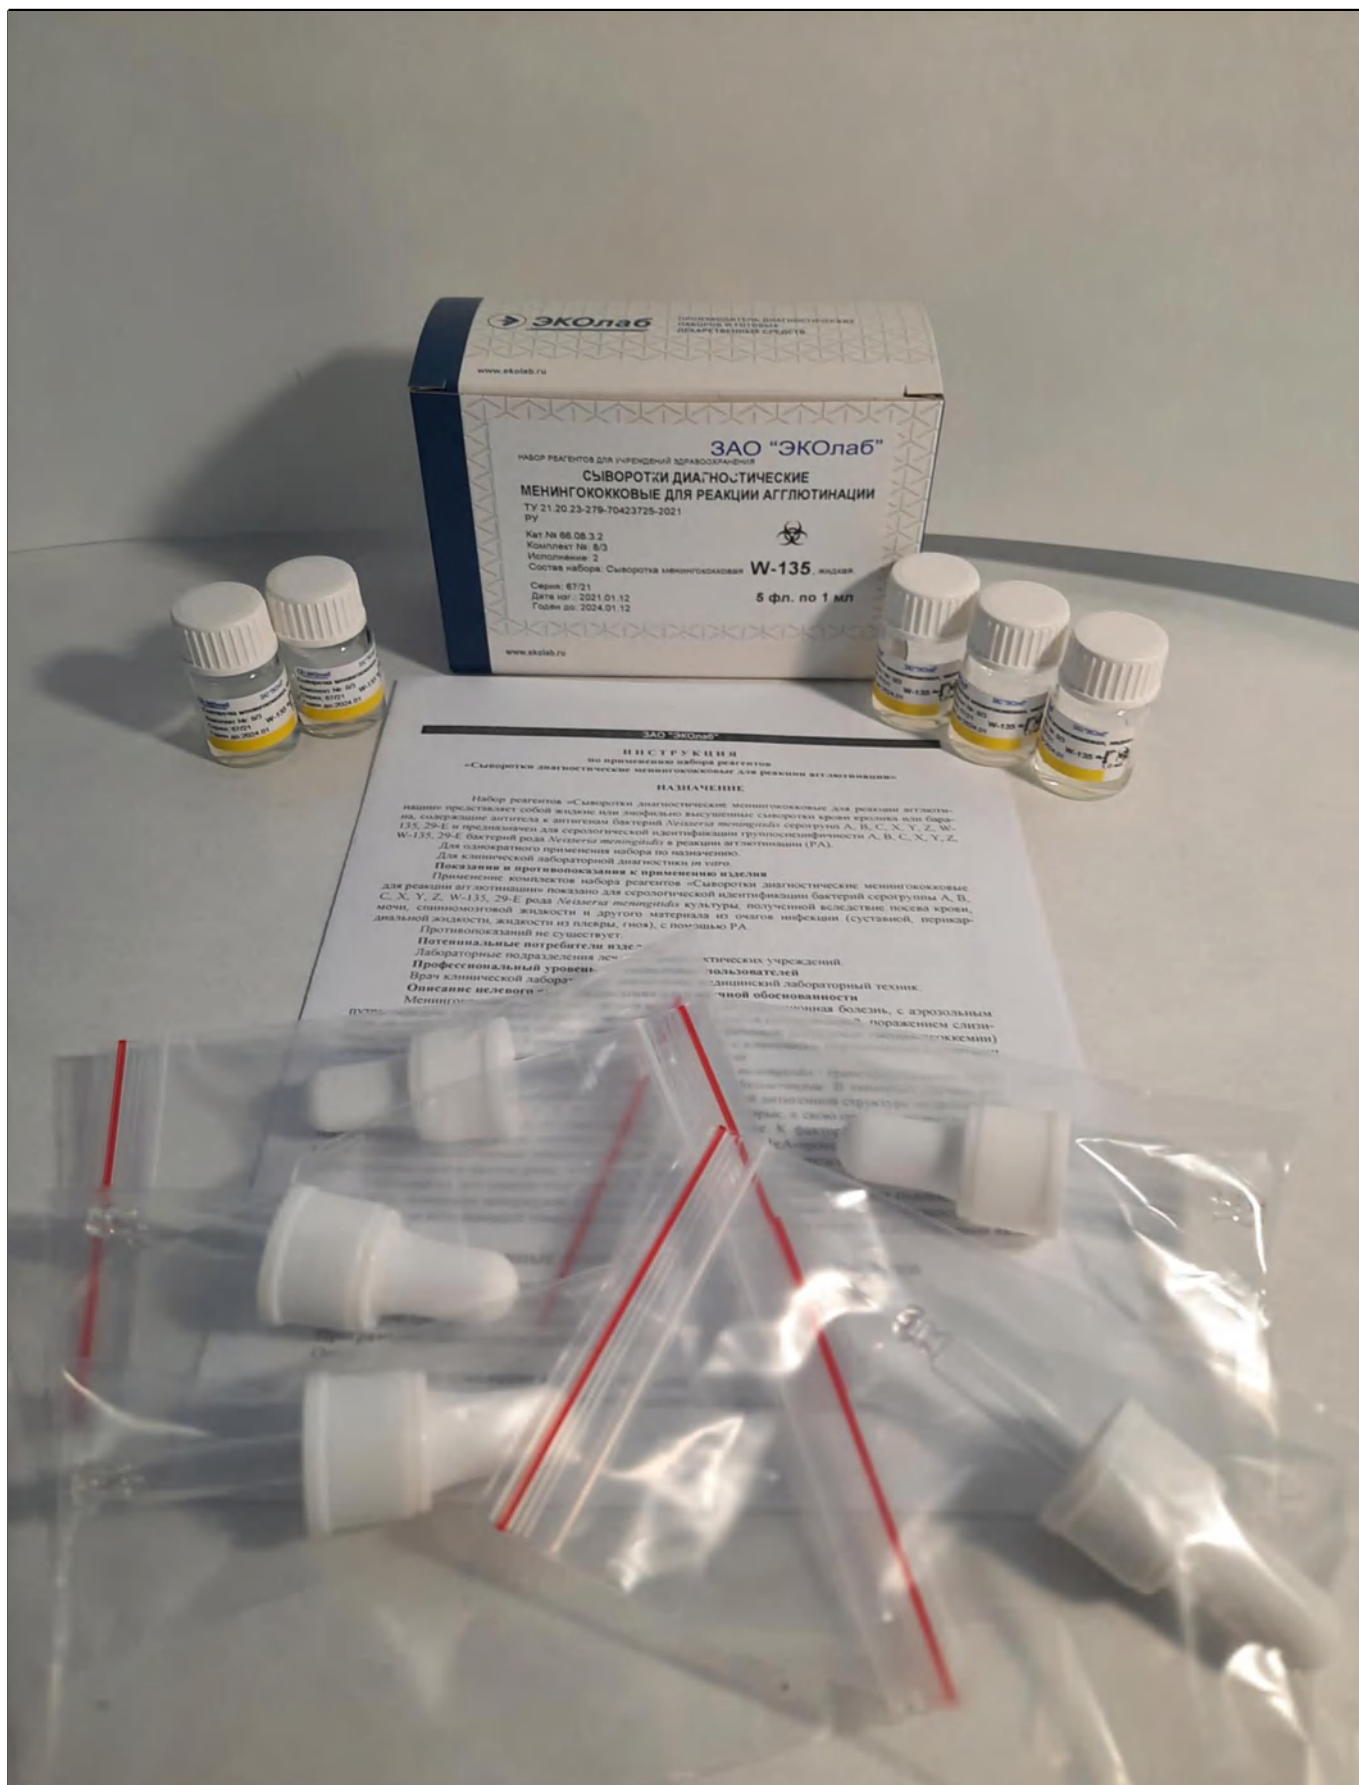

Комплект №8/4, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая W-135, жидкая
серия 68/21 от 2021.01.12

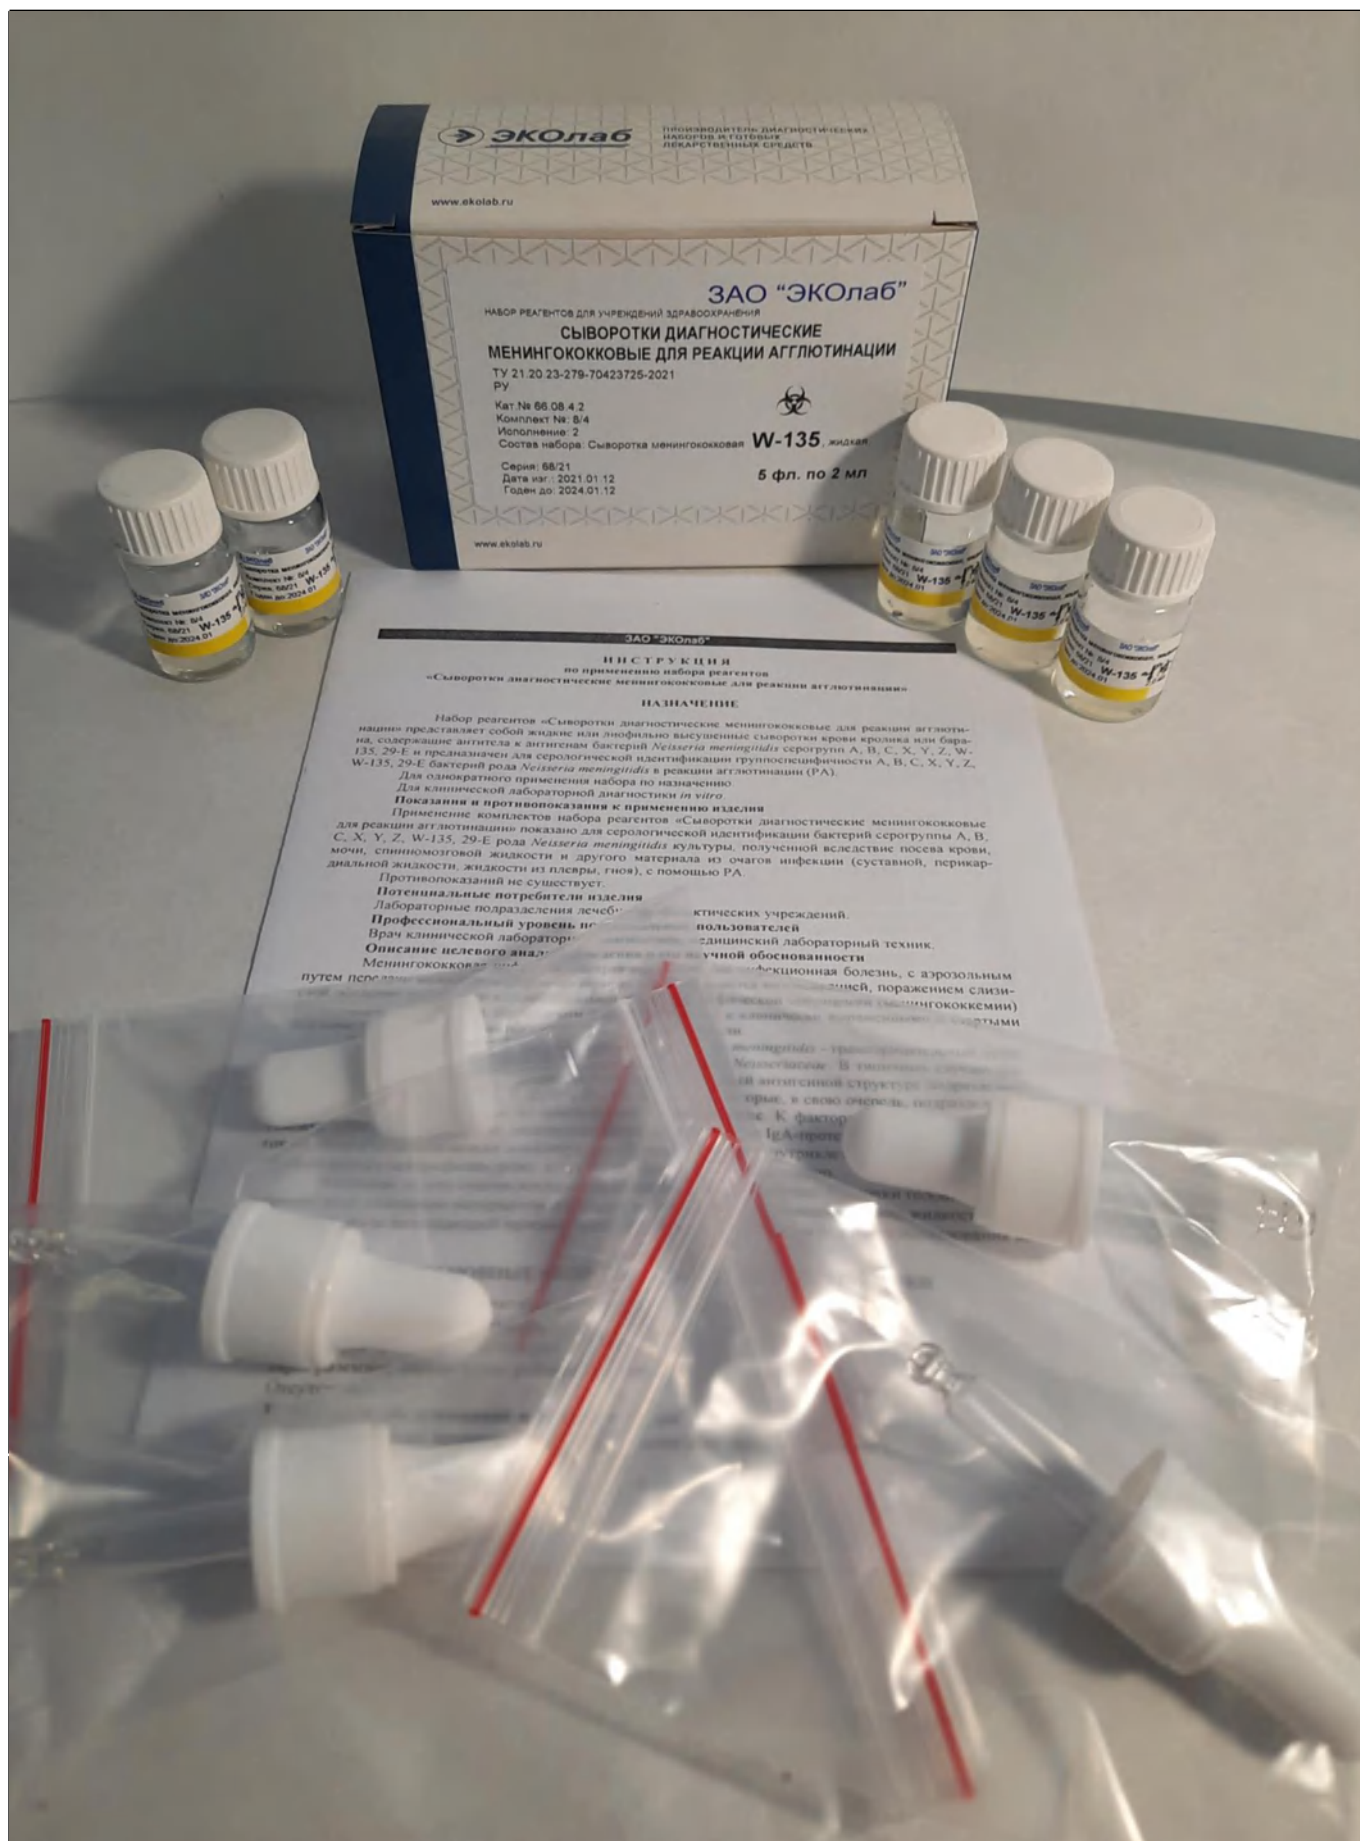


Комплект №9/1, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая 29-Е, сухая
серия 69/21 от 2021.01.12

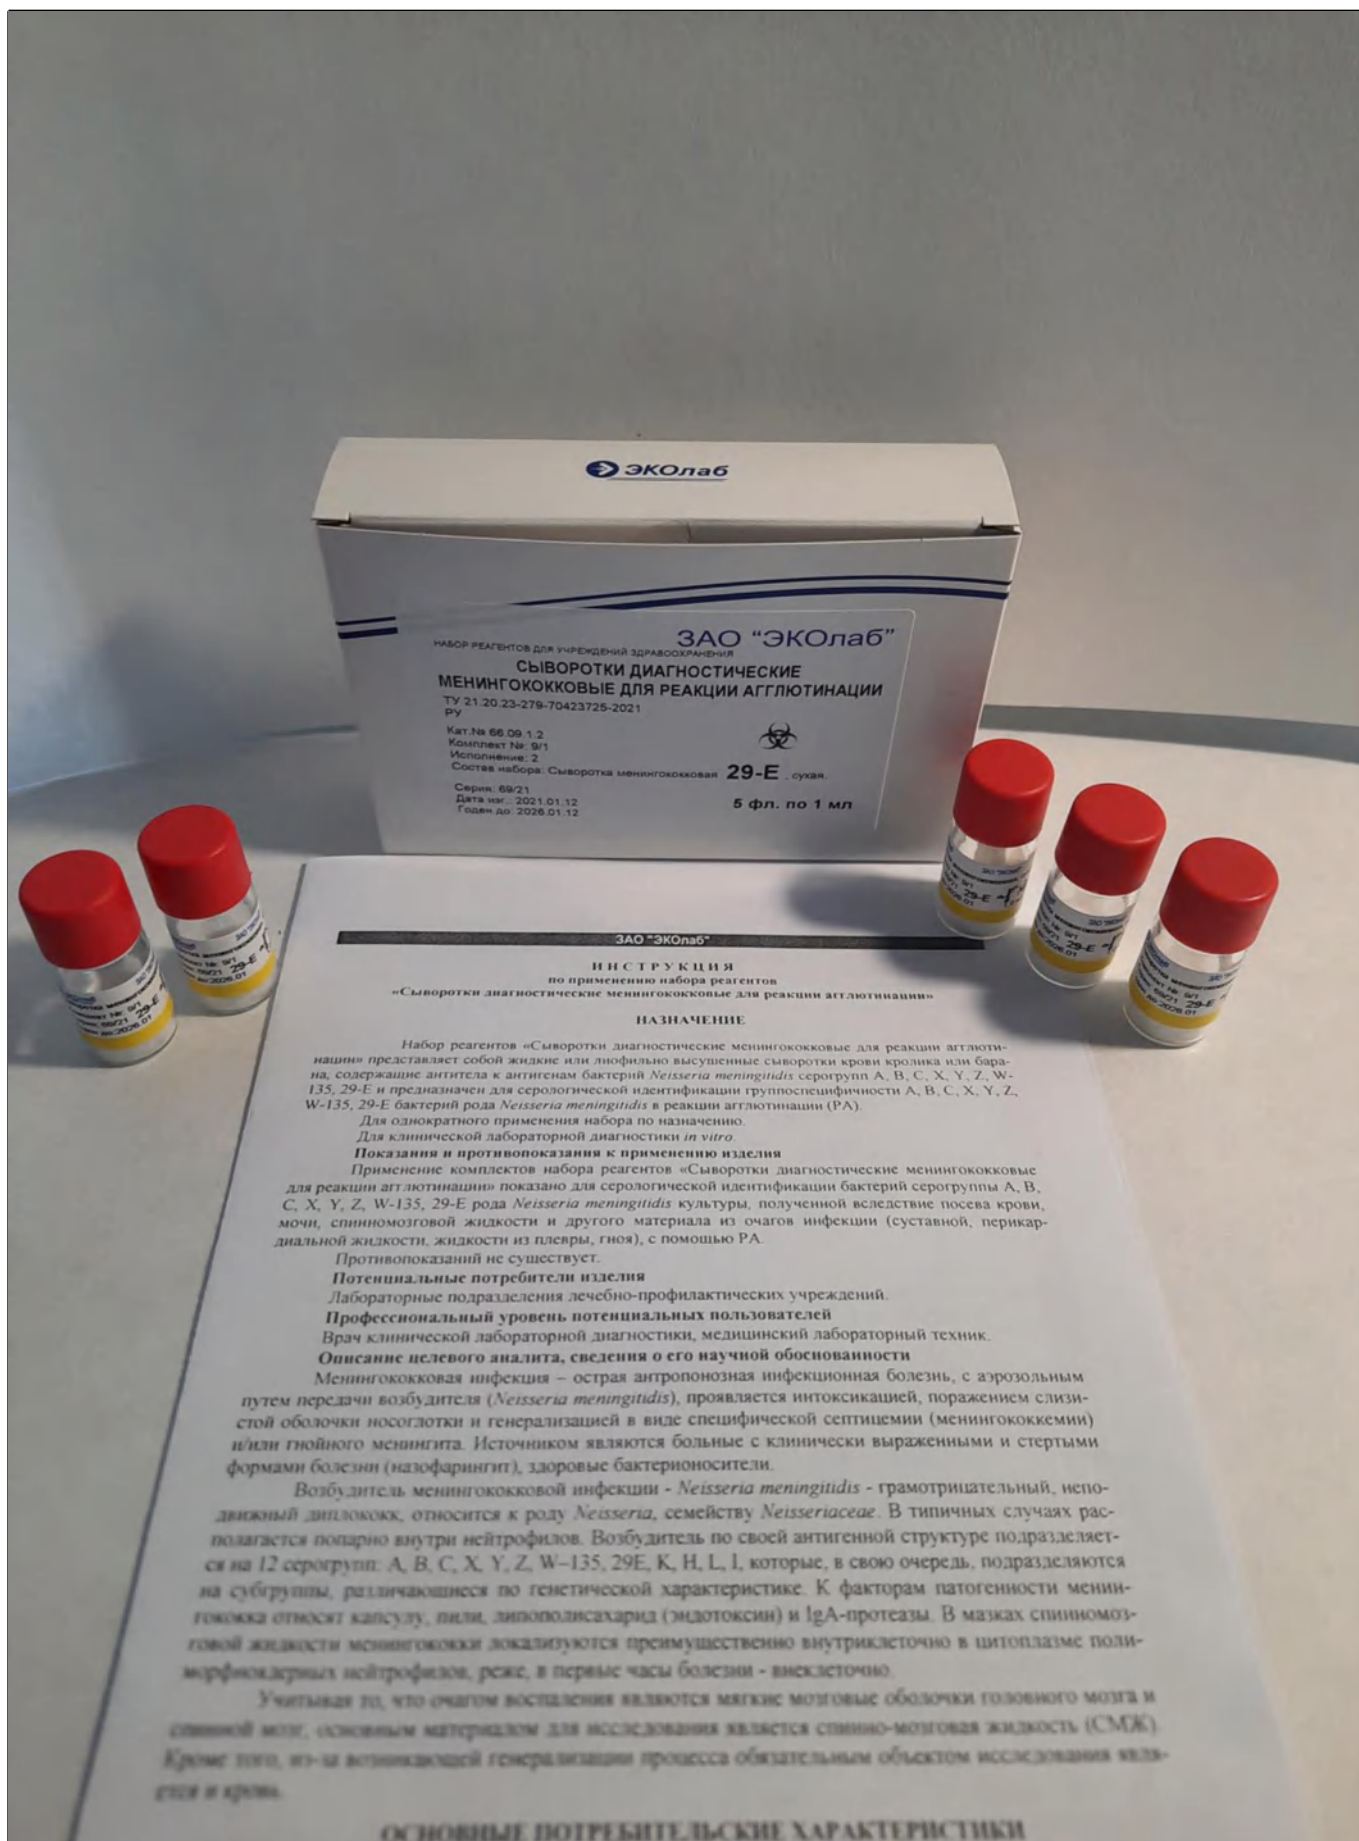


Комплект №9/2, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая 29-Е, сухая

серия 70/21 от 2021.01.12

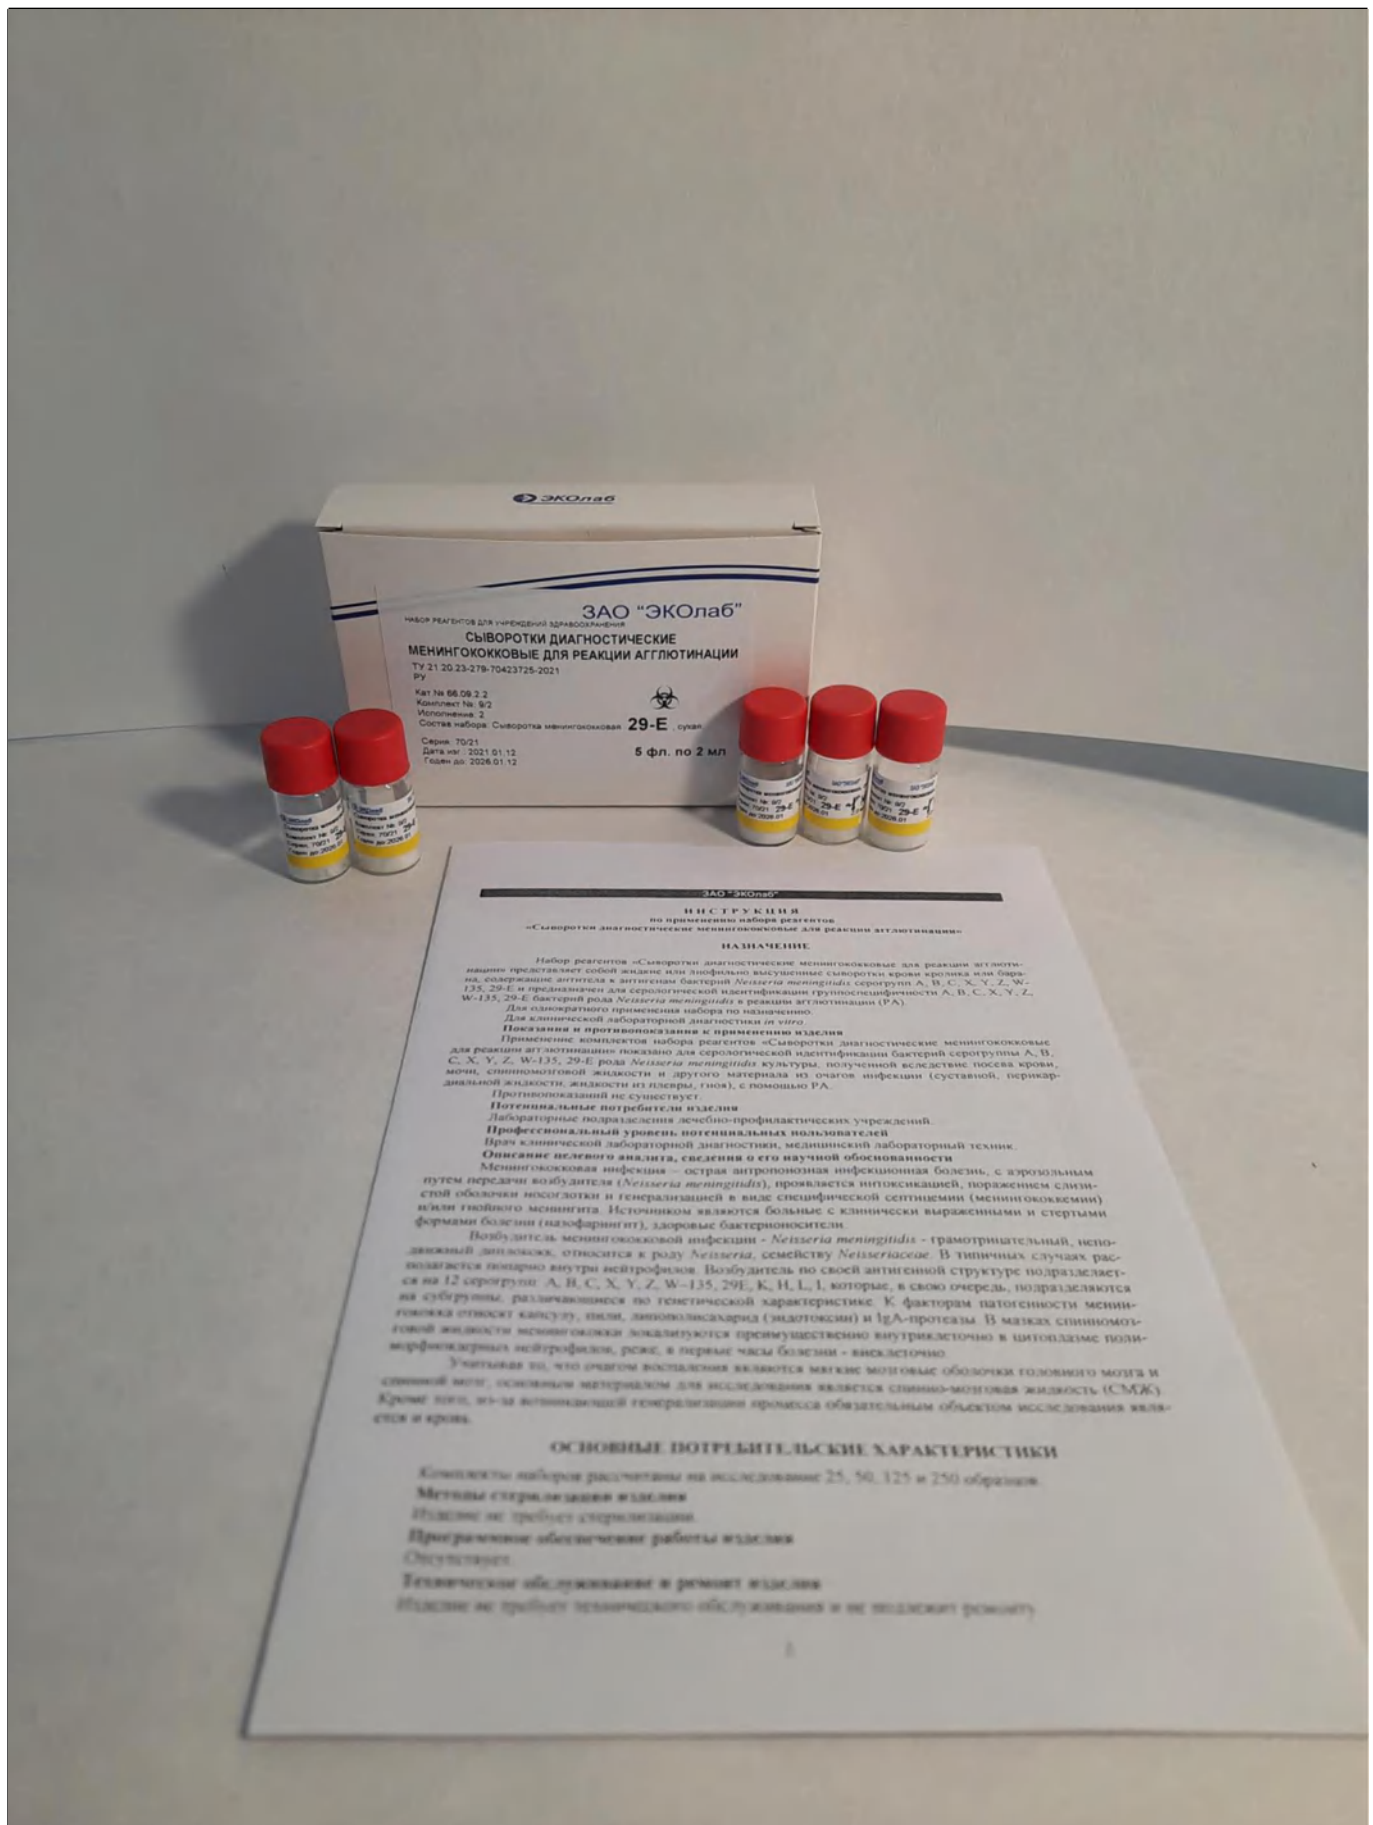


Комплект №9/3, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая 29-Е, жидкая
серия 71/21 от 2021.01.12

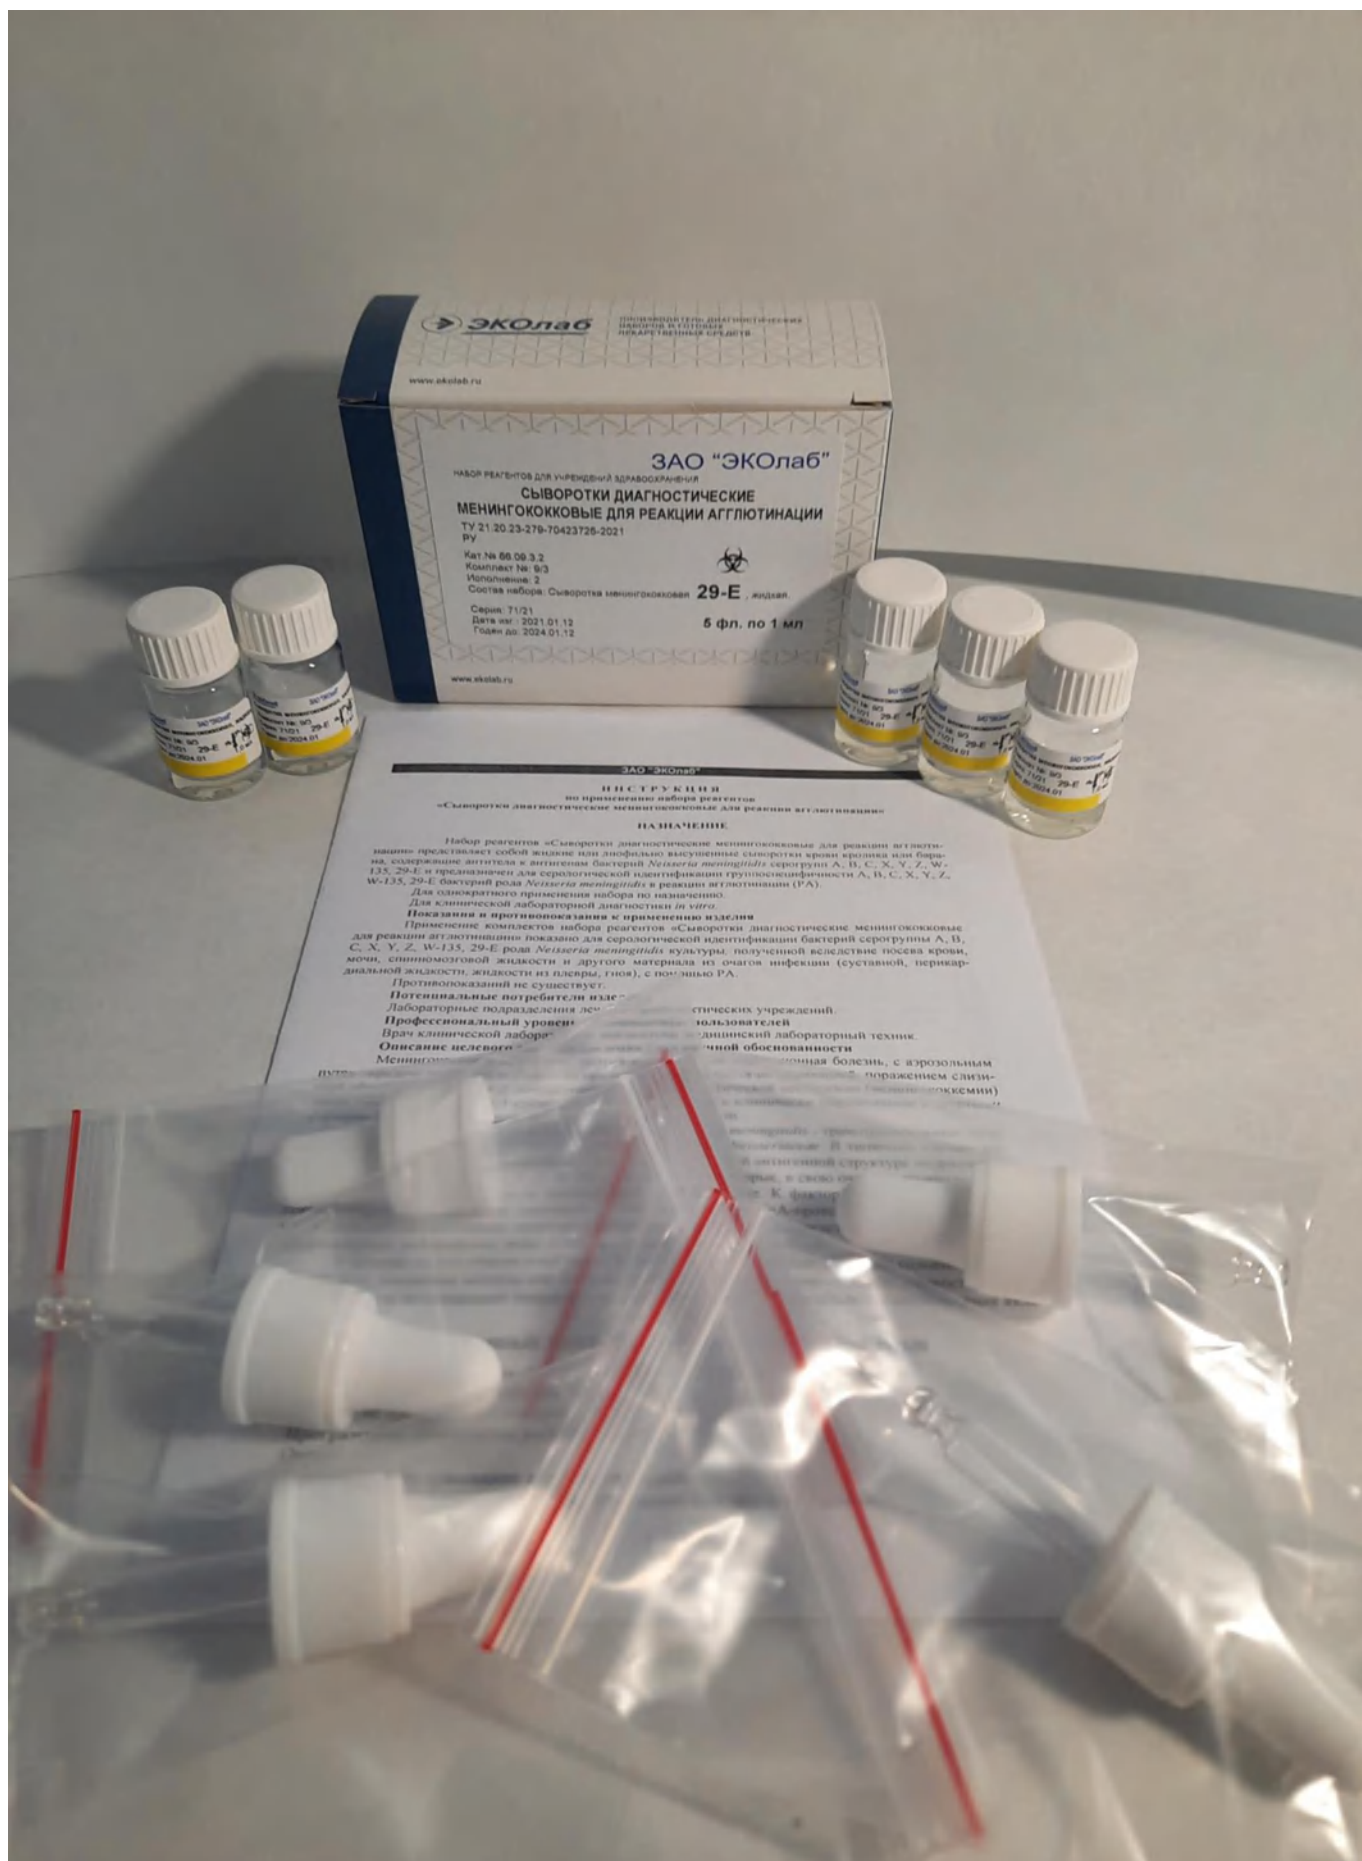

Комплект №9/4, Исполнение 2
Сыворотка менингококковая 29-Е, жидкая

серия 72/21 от 2021.01.12

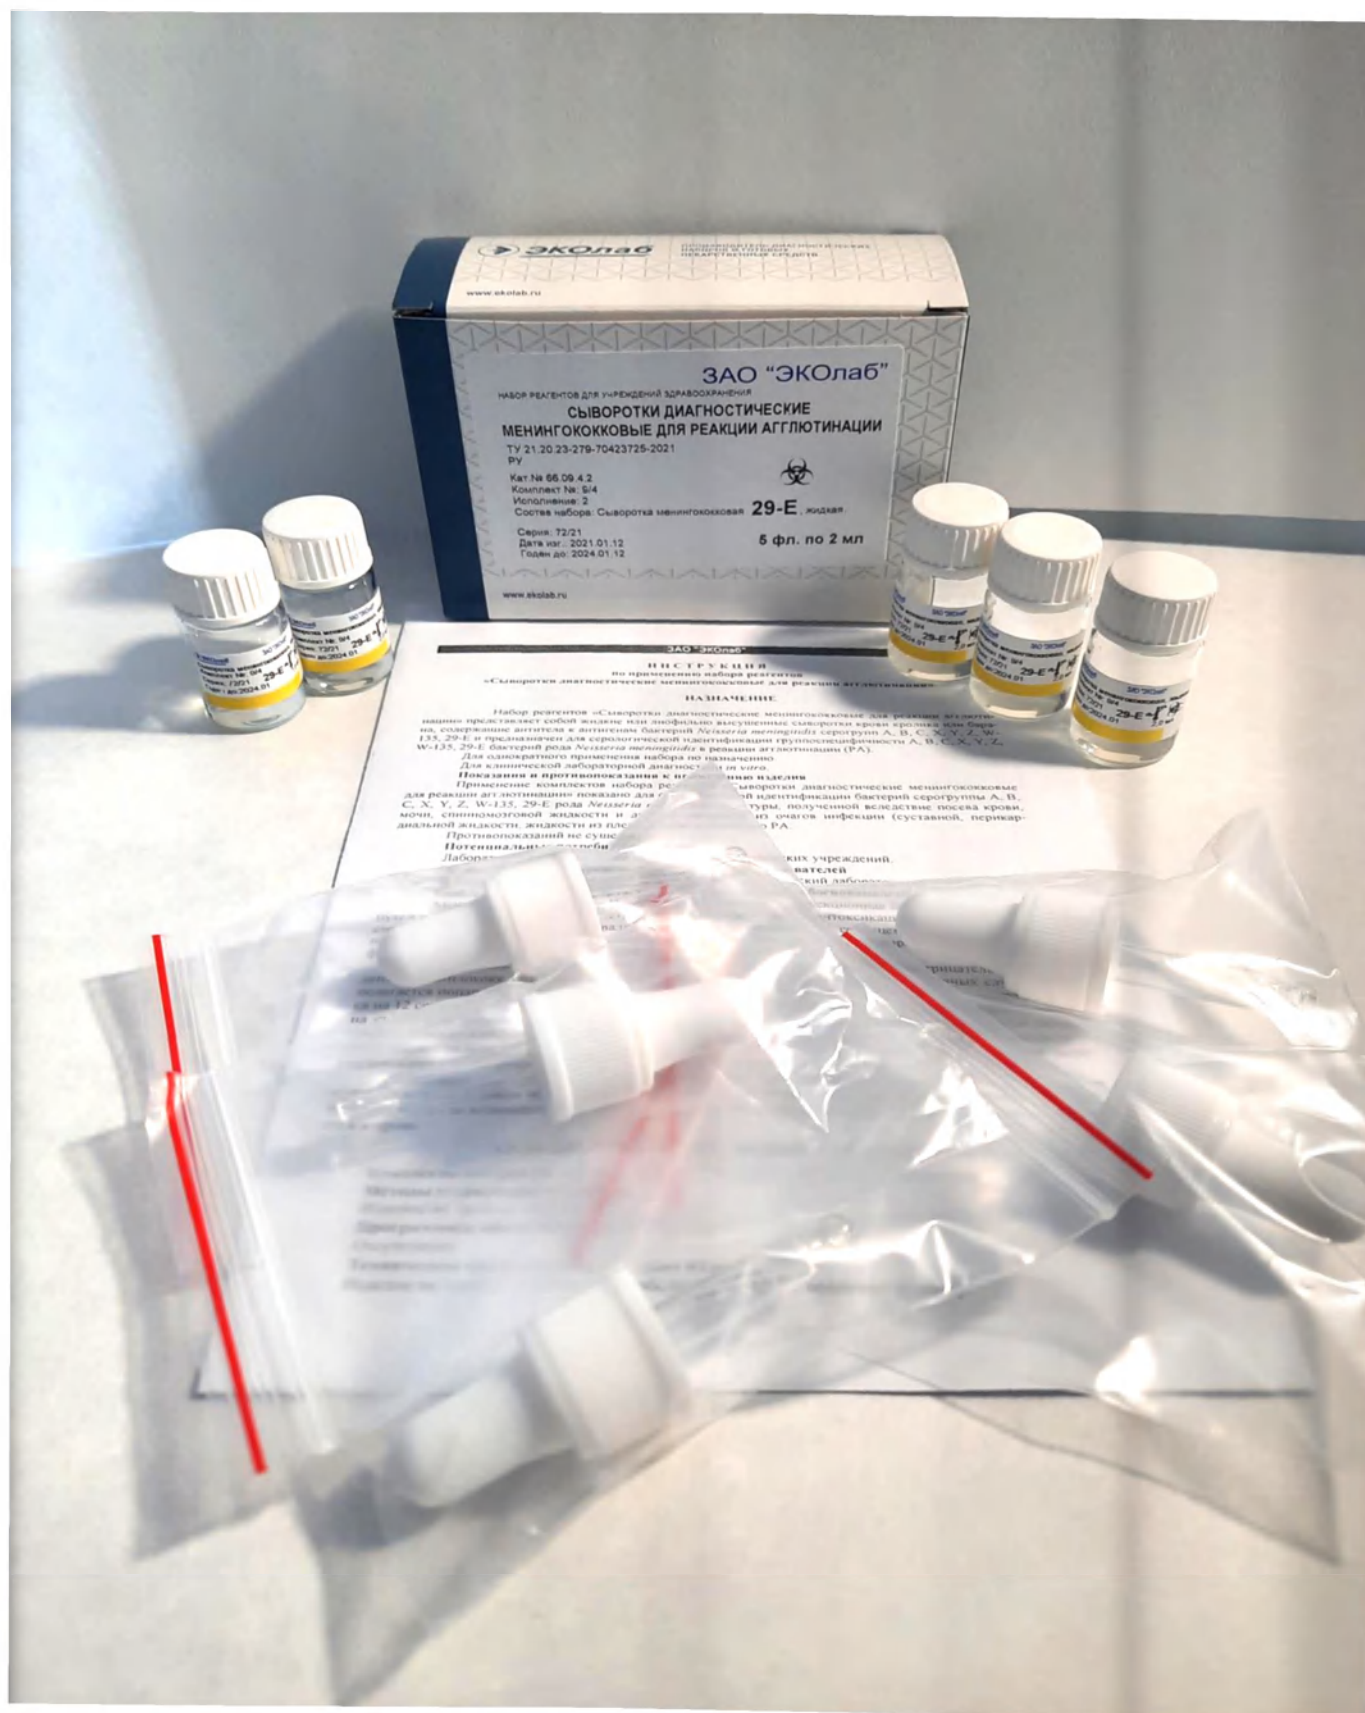

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

68 лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

28 05 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Состав набора: сыворотки менингококковые, сухие

Кат. № 66.01.1 **A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E**

Комплект №: 1/1

Исполнение: 1

Серия: 01/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



8 фл. по 1 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **A**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **B**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **C**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **X**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **Y**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **W-135**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **29-E**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

ЭКОлаб **310°K/5ml**
Сыворотка менингококковая
сухая **Z**
Серия: 01/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Состав набора: сыворотки менингококковые, сухие

Кат. № 66.01.2 А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E

Комплект №: 1/2

Исполнение: 1

Серия: 02/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



8 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
А 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
Z 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
В 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
W-135 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
С 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
29-E 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
X 2,0 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая
сухая
Серия: 02/21
Годен до: 2026.01
Y 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Состав набора: сыворотки менингококковые, жидкие

Кат.№ 66.01.3

Комплект №: 1/3

Исполнение: 1

Серия: 03/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E



8 фл. по 1 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21 W-135
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 03/21 29-E
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Состав набора: сыворотки менингококковые, жидкие
А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29-E

Кат. № 66.01.4

Комплект №: 1/4

Исполнение: 1

Серия: 04/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



8 фл. по 2 мл

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
А

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
В

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
С

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
Х

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
Y

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
Z

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
W-135

Сыворотка менингококковая
жидкая
Серия: 04/21
Годен до: 2024.01
29-E

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

НАСЧ. РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОЛОГИИ

ИЗДАНИЕ 01-09

СЫВОРОТКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ

РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.30.20-276-70423725-2021

ру

Кат. № 68.02.1.1

Комплект №: 2/1

Исполнение: 1

Сыворотка

менингококковая А, сухая



1 фл. по 1 мл

Серия: 05/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб

ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 2/1

Серия: 05/21

Годен до: 2026.01

А

1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

СИВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
"У 21 20 20-219-70423725-2122"

Кат. № 68 02.3.1
Комплект №: 2/3
Исполнение: 1



1 фл. по 1 мл

Сыворотка
МЕНИНГОКОККОВАЯ **A**, жидкая

Серия: 07/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 2/3
Серия: 07/21
Годен до: 2024.01
A 1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21 30 33-376-70423725-2021
ру

Кат № 68.02.4.1
Комплект №: 2/4
Использовано: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
менингококковая А, жидкая

Серия: 08/21
Дата изг.: 2021.01.
Годен до: 2024.01.

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 2/4
Серия: 08/21
Годен до: 2024.01
А 2,0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИДР 36176-028 д/з у-РФСБ-И/

12480004-000

СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.30.21-278-70423725-2121

Р/у

Кат. № 06.03.1.1

Комплект №: 3/1

Исполнения: 1

Сыворотка

менингококковая В, сухая

1 фл. по 1 мл

Серия: 09/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб

3/0 "ЭКОлаб"

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 3/1

Серия: 09/21

Годен до: 2026.01

В.Ю. Борисов

1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

МБСР МАБС-12, 018 П-РЕНД-112
ЗДП-12, 018 П-РЕНД-112

СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21.32.23-278-10423725-2021

Ру
Кат. № 68.03.2.1
Комплект №: 3/2
Исполнение: 1
Сыворотка
менингококковая В, сухая



1 фл. по 2 мл

Серия: 10/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 3/2
Серия: 10/21
Годен до: 2026.01.12 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

2021



Сварочная машина, жидкая
Комплект №: 3/3
Серия: 11/21
Годен до: 2024.01

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21-20-23-276-13433725-0221

Кат. № 66 03.4.1
Комплект №: 3/4.
Исполнение: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
МЕНИНГОКОККОВАЯ В, жидкая

Серия: 12/21
Дата изг.: 2021.01.
Годен до: 2024.01.

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 3/4
Серия: 12/21
Годен до: 2024.01
В.Ю. Борисов
2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021

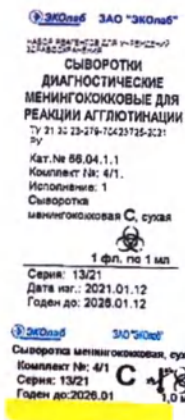

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД (ID CODE)

СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.38-795-704231795-2021

РФ

Кат. № 89.04.2.1

Комплект №: 4/2

Исполнение: 1

Сыворотка

менингококковая С, сухая

1 фл. по 2 мл

Серия: 14/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 4/2

Серия: 14/21

Годен до: 2026.01 2.0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21 30 35-376-70433726-2021

Кат. № 86.04.3.1
Комплект №: 4/3
Исполнение: 1



1 фл. по 1 мл

Сыворотка
МЕНИНГОКОККОВАЯ С, ЖИДКАЯ

Серия: 15/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 4/3
Серия: 15/21
Годен до: 2024.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

"11" 2021



ЗАО "ЭКОлаб"

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ПРОДУКТА
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21-20-23-279-10423735-2021
РФ

Кат. № 66.04.4.1
Комплект №: 4/4
Исполнение: 1



1 фл. по 2 мл


Сыворотка
менингококковая С, жидкая


Серия: 16/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЭКОлаб ЭКОлаб
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 4/4
Серия: 16/21
Годен до: 2024.01
2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии
и НПО Биохимия
СОГЛАСОВАНО
Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021

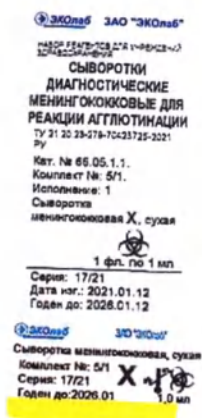


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ЭКОлаб»

СЫВОРОТКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ

РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21 20 23-278-10423726-2021

Р/у

Кат. № 85.05.2.1.

Комплект №: 5/2.

Исполнение: 1

Сыворотка

менингококковая X, сухая



1 фл. по 2 мл

Серия: 18/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 5/2

Серия: 18/21

Годен до: 2026.01



2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотки диагностические
менингококковые для реакции агглютинации

ТУ 21-22-23-279-10433725-2021

ру

Кат. № 66.05.3.1

Комплект №: 5/3

Исполнение: 1

Сыворотка
менингококковая X, жидкая

Серия: 19/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



1 фл. по 1 мл

ЭКОлаб

ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотка менингококковая, жидкая

Комплект №: 5/3

Серия: 19/21

Годен до: 2024.01



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

УД 21 22 23-279-10423725-2021

Кат. № 88.05.4.1
Комплект №: 5/4,
Исполнение: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
МЕНИНГОКОККОВАЯ X, жидкая

Серия: 20/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 5/4 X
Серия: 20/21
Годен до: 2024.01.12 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР КРАТКОГО ДТЗ V-18428-1/2

127482094-9-74

СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21 20.25-774-70425725-2021

РУ

Кат. № 66.08.1.1.

Комплект №: 6/1.

Исполнения: 1

Сыворотка

менингококковая Y, сухая



1 фл. по 1 мл

Серия: 21/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 6/1

Серия: 21/21

Годен до: 2026.01



1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

11 " 06 " 2021



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

СЫВОРОТКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21 20 28-178-10433735-3321
ру
Кат № 66.08.2.1.
Комплект №: 6/2.
Исполнения: 1
Сыворотка
менингококковая Y, сухая



1 фл. по 2 мл
Серия: 22/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2026.01.12

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 6/2
Серия: 22/21
Годен до: 2026.01.12

2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21.30.33-275-70433725-0221
ЗУ

Кат. № 66.05.3.1
Комплект №: 6/3.
Исполнение: 1



Сыворотка
менингококковая Y, жидкая

Серия: 23/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 6/3
Серия: 23/21
Годен до: 2024.01.12

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21-25-279-10421725-3221

Кат. № 88.08.4.1
Комплект №: 6/4
Исполнение: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
менингококковая Y, жидкая

Серия: 24/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЭКОлаб **ЭКОлаб**
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 6/4
Серия: 24/21
Годен до: 2024.01.12
2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

" " " 2021



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ НАУКИ И МЕДИЦИНЫ

СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.25-279-70435725-3021

РУ

Кат. № 66.07.1.1.

Комплект №: 7/1.

Исполнения: 1

Сыворотка

менингококковая Z, сухая

1 фл. по 1 мл

Серия: 25/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 7/1

Серия: 25/21

Годен до: 2026.01



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

2021



_____ Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РАБОЧЕ-ГОТОВЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗОВ
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 91 20 20-219-10433720-2021

Хит № 66.07.3.1
Комплект №: 7/3.
Исполнения: 1



1 фл. по 1 мл

Сыворотка
МЕНИНГОКОККОВАЯ Z, жидкая

Серия: 27/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЭКОлаб
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 7/3
Серия: 27/21
Годен до: 2024.01
Z 1.0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 9. 35.30-379-15-201205-1-1

Кат № 69.07.4.1
Комплект №: 7/4
Исполнения: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
менингококковая Z, жидкая

Серия: 28/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб" 3АО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 7/4
Серия: 28/21
Годен до: 2024.01



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
ТУ 21 30 28-279-70433725-2021

Р/у
Кат. № 88.08.1.1
Комплект №: 8/1.
Исполнение: 1
Сыворотка
менингококковая W-135,
сухая

1 фл. по 1 мл

Серия: 29/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 8/1
Серия: 29/21 W-135
Годен до: 2026.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОЛОГИИ

СИВОРОТКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ

РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 31 30 35-378-70423725-3021

Р/у

Кат. № 88.08.2.1

Комплект №: 8/2.

Исполнение: 1

Сыворотка

менингококковая W-135,

сухая



1 фл. по 2 мл

Серия: 30/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 8/2

Серия: 30/21 W-135

Годен до: 2026.01

2,0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО "ЭКОлаб"

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 31 30 31-319-10433719-0121

Кат. № 66.08.3.1
Комплект №: 8/3,
Исполнение: 1



1 фл. по 1 мл

Сыворотка
менингококковая W-135, жидкая

Серия: 31/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 8/3
Серия: 31/21 W-135
Годен до: 2024.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ЗАО "ЭКОлаб"

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 31 30 29-279-70423725-2021

Кат. № 66.08.4.1
Комплект №. 8/4,
Исполнение: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
менингококковая W-135, жидкая

Серия: 32/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 8/4
Серия: 32/21 W-135
Годен до: 2024.01 2.0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

Генеральный директор

В.Ю. Борисов

2021



—A800 80A"2—700 578 V—P8—(28—)

**СЫВОРОТКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**
ТУ 21 20 23-278-75423725-2021

Кат. № 55.09.1.1.
Комплект №: 9/1.
Исполнение: 1

Сыворотка
маннингококковая 29-Е,
сухая ()

1 фп. № 1 МП

Серия: 33/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2026.01.12

Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 9/1
Серия: 33/21 29-E 
Годен до: 2026.01 1,0 мл

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

НАБОР РЕАКТИВОВ ДЛЯ ИММУНОЛОГИИ

СИВОРОТКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ

РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21-22-218-704212125-2021

RU

Кат. № 86.08.2.1.

Комплект №: 0/2.

Исполнение: 1

Сыворотка

менингококковая 29-Е,

сухая



1 фл. по 2 мл

Серия: 34/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотка менингококковая, сухая

Комплект №: 0/2

Серия: 34/21 29-Е

Годен до: 2026.01



2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОКОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21 32 25-279-70433726-2021

29

Кат. № 68.09.3.1

Комплект №: 9/3

Исполнения: 1

Сыворотка
менингококковая 29-Е, жидкая

Серия: 35/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



1 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 9/3
Серия: 35/21 29-Е
Годен до: 2024.01 1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

"11" 2021



ЗАО "ЭКОлаб"

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 31 20 21-278-10423726-2021

Кат. № 66.09.4.1
Комплект №: 9/4.
Исполнение: 1



1 фл. по 2 мл

Сыворотка
менингококковая 29-Е, жидкая

Серия: 36/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 9/4
Серия: 36/21 29-Е
Годен до: 2024.01 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

" 17 " 2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.02.1.2

Комплект №: 2/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая А, сухая.



Серия: 41/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 2/1
Серия: 41/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.02.2.2

Комплект №: 2/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **A**, сухая.



Серия: 42/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 2 мл

ЭКОлаб **ЭКОлаб**
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 2/2
Серия: 42/21
Годен до: 2026.01
A 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.02.3.2

Комплект №: 2/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая А, жидкая.



Серия: 43/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 2/3
Серия: 43/21
Годен до: 2024.01
А 1.0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
ру

Кат.№ 66.02.4.2

Комплект №: 2/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **A**, жидкая.



Серия: 44/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 2/4
Серия: 44/21
Годен до: 2024.01
A 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

ру

Кат. № 66.03.1.2

Комплект №: 3/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **В**, сухая.



Серия: 45/21

Дата изг.: 2021.01

Годен до: 2026.01

5 фл. по 1 мл

 ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 3/1
Серия: 45/21
Годен до: 2026.01
В 
1,0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
РУ

Кат. № 66.03.2.2

Комплект №: 3/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая В, сухая.

Серия: 46/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 3/2
Серия: 46/21
Годен до: 2026.01.12
2,0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.03.3.2

Комплект №: 3/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **В**, жидкая.



Серия: 47/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 3/3
Серия: 47/21
Годен до: 2024.01
1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат.№ 66.03.4.2

Комплект №: 3/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая В, жидкая.

Серия: 48/21

Дата изг.: 2021.01

Годен до: 2024.01



5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 3/4
Серия: 48/21
Годен до: 2024.01
В 2.0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.04.1.2

Комплект №: 4/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **С**, сухая.

Серия: 49/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



5 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 4/1
Серия: 49/21
Годен до: 2026.01
С 1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.04.2.2

Комплект №: 4/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **С**, сухая.



Серия: 50/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 4/2
Серия: 50/21
Годен до: 2026.01
С 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

"11" 2021

ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 86.04.3.2

Комплект №: 4/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **C**, жидкая.

Серия: 51/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



5 фл. по 1 мл

ЭКОлаб 510 21021
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 4/3
Серия: 51/21
Годен до: 2024.01
C 1,0 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.04.4.2

Комплект №: 4/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **С**, жидкая.

Серия: 52/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 4/4
Серия: 52/21
Годен до: 2024.01
2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.05.1.2

Комплект №: 5/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая X, сухая.




Серия: 53/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 1 мл




Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.05.2.2

Комплект №: 5/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая X, сухая.



Серия: 54/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 5/2
Серия: 54/21
Годен до: 2026.01
X ~ 10
2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
РУ

Кат. № 66.05.3.2
Комплект №: 5/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **X**, жидкая.

Серия: 55/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12



5 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 5/3
Серия: 55/21
Годен до: 2024.01
X

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.05.4.2

Комплект №: 5/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая X, жидкая.

Серия: 56/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 5/4
Серия: 56/21
Годен до: 2024.01
X 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
РУ

Кат. № 65.06.1.2

Комплект №: 6/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая Y, сухая.



Серия: 57/21

Дата изг.: 2021.01

Годен до: 2026.01

5 фл. по 1 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 6/1
Серия: 57/21
Годен до: 2026.01
1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
РУ

Кат. № 68.06.2.2

Комплект №: 6/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая  **Y**, сухая.

Серия: 58/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 2 мл

 ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 6/2
Серия: 58/21
Годен до: 2026.01
 **Y**  **2,0 мл**


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

"11" 01 2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.06.3.2

Комплект №: 6/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая Y, жидкая.



Серия: 59/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 1 мл

 ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 6/3
Серия: 59/21
Годен до: 2024.01
 1,0 мл


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.


Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
РУ

Кат. № 66.06.4.2

Комплект №: 6/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **Y**, жидкая.



Серия: 60/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 2 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 6/4
Серия: 60/21
Годен до: 2024.01
Y 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
ру

Кат. № 66.07.1.2

Комплект №: 7/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **Z**, сухая.



Серия: 61/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 1 мл

Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 7/1
Серия: 61/21
Годен до: 2026.01
Z
1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

2021



Серия: 62/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2026.01.12

Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 7/2
Серия: 62/21
Годен до: 2026.01

Leaf



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат.№ 66.07.3.2

Комплект №: 7/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая Z, жидкая.



Серия: 63/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 1 мл

ЗАО ЭКОлаб
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 7/3
Серия: 63/21
Годен до: 2024.01.12
1,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

Генеральный директор

В.Ю. Борисов

2021



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

TY 21.20.23-279-70423725-2021
PV

Кат. № 66.07.4.2

Комплект №: 7/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **Z**, жидкая.

Серия: 64/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 1 мл



Синопортыс менингококковая, жидка
Комплект №: 774
Серия: 54/21
Годен до: 2024.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

и НПО Биохимия

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.08.1.2

Комплект №: 8/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **W-135**, сухая.

Серия: 65/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



W-135, сухая.

5 фл. по 1 мл

 ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 8/1
Серия: 65/21 **W-135**
Годен до: 2026.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.08.2.2

Комплект №: 8/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **W-135**, сухая.



Серия: 66/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12

5 фл. по 2 мл

 **ЗАО «ЭКОлаб»**
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 8/2
Серия: 66/21 **W-135**
Годен до: 2026.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
ру

Кат. № 66.08.3.2

Комплект № 8/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая W-135, жидкая.

Серия: 67/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12



5 фл. по 1 мл

ЭКОлаб
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект № 8/3
Серия: 67/21 W-135
Годен до: 2024.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

" 17 " 01 2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.08.4.2

Комплект №: 8/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **W-135**, жидкая.



Серия: 68/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 2 мл

 ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 8/4
Серия: 68/21 **W-135**
Годен до: 2024.01.12


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

 Я.В. Мишуткина

 Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.09.1.2

Комплект №: 9/1

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **29-Е**, сухая.

Серия: 69/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



5 фл. по 1 мл

ЭКОлаб 30°30m9°
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 9/1
Серия: 69/21 **29-Е**
Годен до: 2026.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
РУ

Кат. № 66.09.2.2

Комплект №: 9/2

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **29-Е**, сухая.

Серия: 70/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2026.01.12



29-Е, сухая.

5 фл. по 2 мл

ЭКОлаб **ЭКОлаб**
Сыворотка менингококковая, сухая
Комплект №: 9/2
Серия: 70/21 **29-Е**
Годен до: 2026.01 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно не коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021
ру

Кат. № 66.09.3.2
Комплект №: 9/3

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **29-Е**, жидкая.



Серия: 71/21
Дата изг.: 2021.01.12
Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 1 мл

 **ЗАО «ЭКОлаб»**
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 9/3
Серия: 71/21 29-Е 
Годен до: 2024.01 1.0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021



ЗАО «ЭКОлаб»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕНИНГОКОККОВЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

ТУ 21.20.23-279-70423725-2021

РУ

Кат. № 66.09.4.2

Комплект №: 9/4

Исполнение: 2

Состав набора: Сыворотка менингококковая **29-Е**, жидкая.



Серия: 72/21

Дата изг.: 2021.01.12

Годен до: 2024.01.12

5 фл. по 2 мл

ЗАО «ЭКОлаб»
Сыворотка менингококковая, жидкая
Комплект №: 9/4
Серия: 72/21 **29-Е**
Годен до: 2024.01 2,0 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, знак «только для *in vitro* диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор НПО Иммунологии

и НПО Биохимия

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Я.В. Мишуткина

Т.В. Юрина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

67 лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.

