



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «БиоХимМак Диагностика»



Черноглазов В.М.

«07» марта 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор калибраторов BÜHLMANN fCAL turbo Calibrator Kit для использования в ходе
количественного определения кальпротектина в образцах кала человека методом
турбидиметрического анализа


Набор калибраторов BÜHLMANN fCAL turbo Calibrator Kit для использования в ходе количественного определения кальпротектина в образцах кала человека методом турбидиметрического анализа в составе:


1. Калибратор (CAL 1), флакон (1 мл.) – 1 шт.
2. Калибратор (CAL 2), флакон (1 мл.) – 1 шт.
3. Калибратор (CAL 3), флакон (1 мл.) – 1 шт.
4. Калибратор (CAL 4), флакон (1 мл.) – 1 шт.
5. Калибратор (CAL 5), флакон (1 мл.) – 1 шт.
6. Калибратор (CAL 6), флакон (1 мл.) – 1 шт.
7. Эксплуатационная документация в составе:

- инструкция по применению, 1 шт.

- сертификат контроля качества, 1 шт.

Набор калибраторов BÜHLMANN fCAL turbo Calibrator Kit для использования в ходе количественного определения кальпротектина в образцах кала человека методом турбидиметрического анализа в составе:

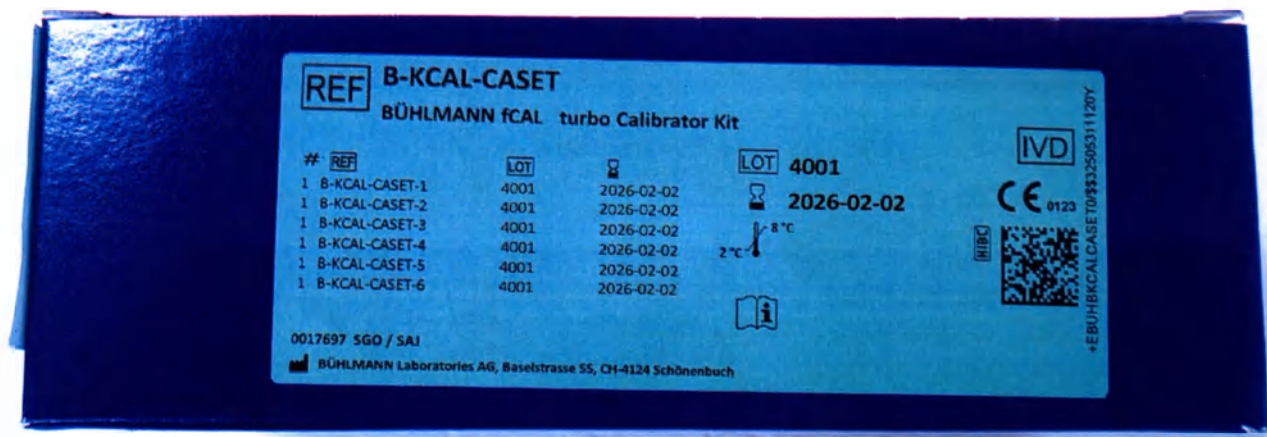

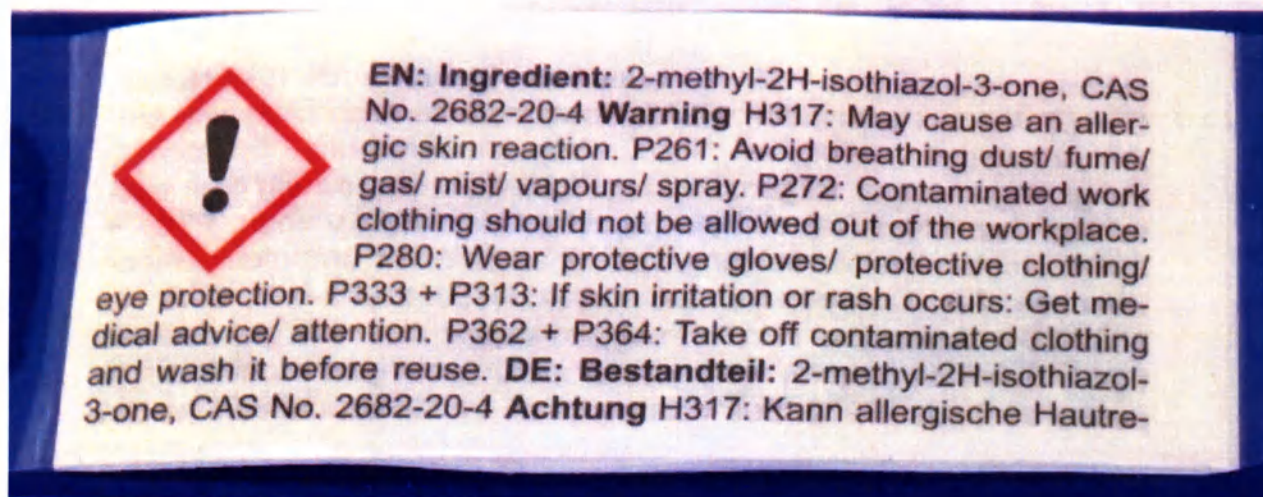



АО "БиоХимМак Диагностика"

ISO 9001

bcmd.ru
info@bcm.ru

119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 647-27-40

EC REP




BÜHLMANN Germany GmbH
Marie-Curie-Straße 8
DE-79539 Lörrach



BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
CH-4124 Schönenbuch
www.buhlmannlabs.ch

BÜHLMANN


Made in Switzerland

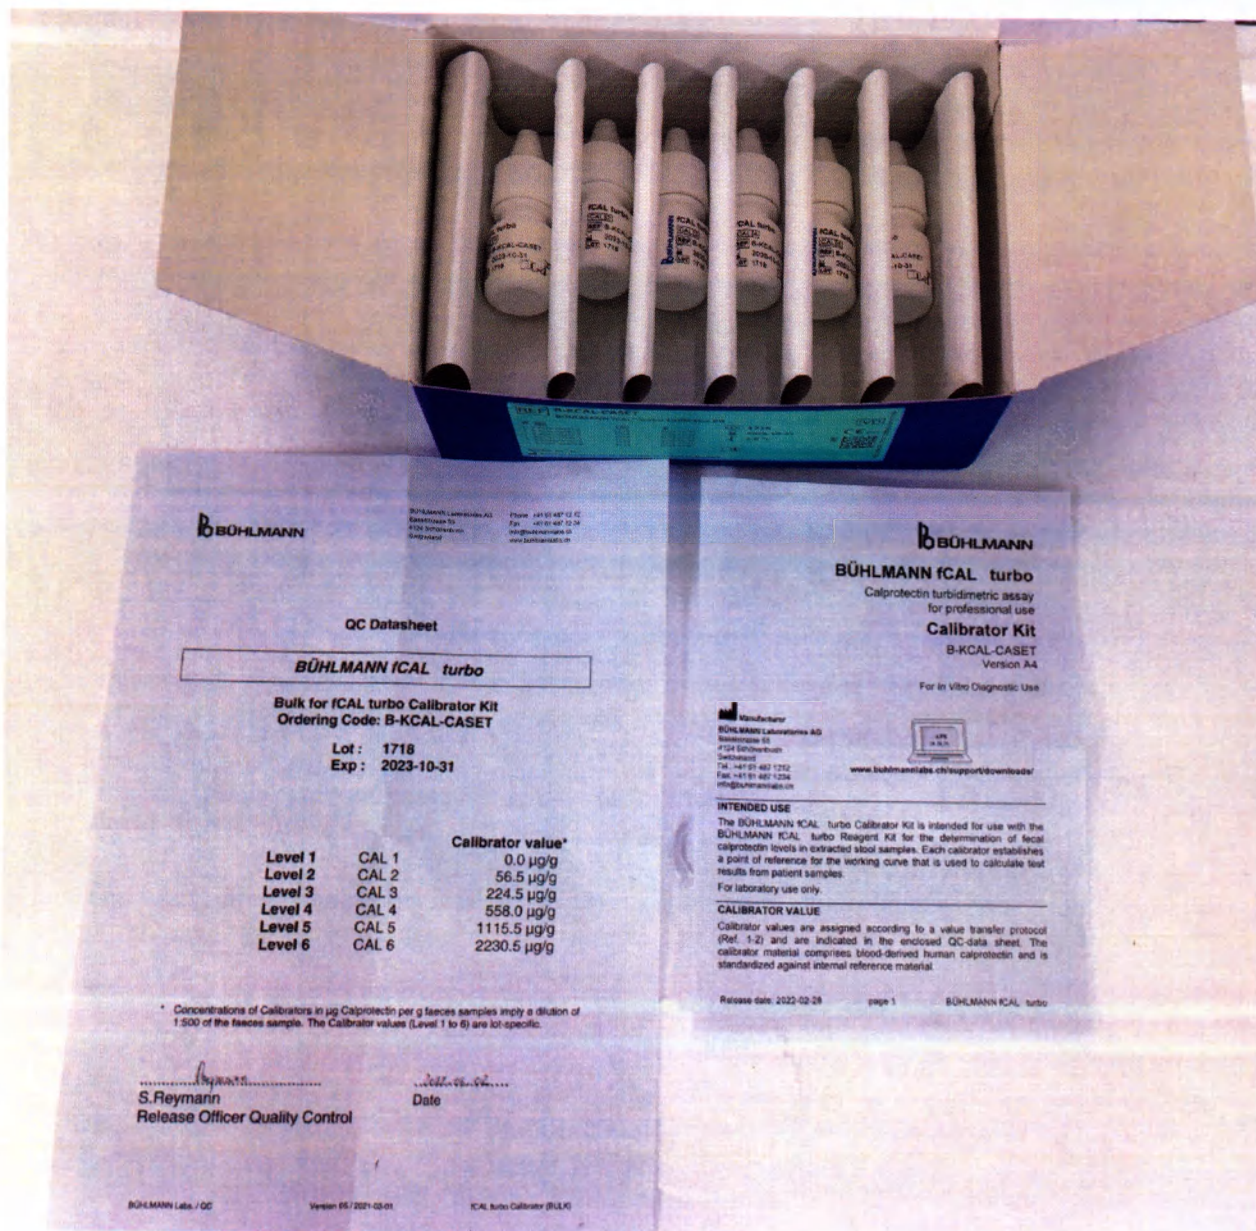





1. Калибратор (CAL 1), флакон (1 мл.) – 1 шт.

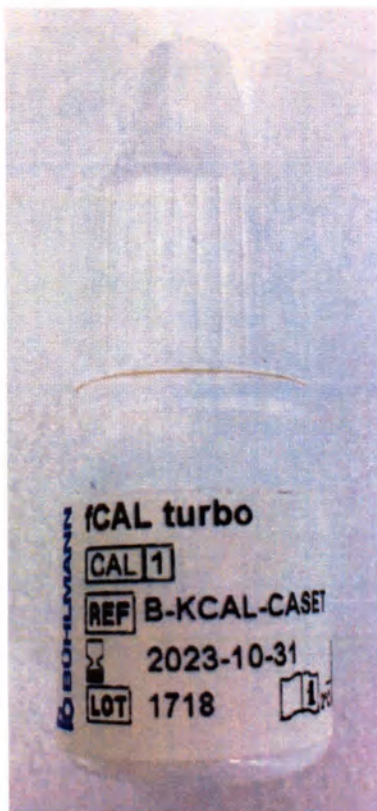

2. Калибратор (CAL 2), флакон (1 мл.) – 1 шт.



3. Калибратор (CAL 3), флакон (1 мл.) – 1 шт.



4. Калибратор (CAL 4), флакон (1 мл.) – 1 шт.



5. Калибратор (CAL 5), флакон (1 мл.) – 1 шт.



6. Калибратор (CAL 6), флакон (1 мл.) – 1 шт.





Макет русскоязычного стикера для медицинского изделия

Набор калибраторов BÜHLMANN fCAL turbo Calibrator Kit для использования в ходе количественного определения кальпротектина в образцах кала человека методом турбидиметрического анализа в составе:

1. Калибратор (CAL 1), флакон (1 мл.) – 1 шт.
2. Калибратор (CAL 2), флакон (1 мл.) – 1 шт.
3. Калибратор (CAL 3), флакон (1 мл.) – 1 шт.
4. Калибратор (CAL 4), флакон (1 мл.) – 1 шт.
5. Калибратор (CAL 5), флакон (1 мл.) – 1 шт.
6. Калибратор (CAL 6), флакон (1 мл.) – 1 шт.
7. Эксплуатационная документация в составе:
 - инструкция по применению, 1 шт.
 - сертификат контроля качества, 1 шт.

Только для профессионального применения!

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Инактивировано! Для диагностики in vitro!

Производитель: *BÜHLMANN Laboratories AG (БЮЛЬМАНН Лабораториз АГ)
Baselstr. 55, 4124 Schönenbuch, SWITZERLAND
(Базельштрассе 55, 4124 Шёненбух, Швейцария)
Тел. +41 61 487 12 12, E-mail: info@buhlmannlabs.ch*

Уполномоченный
представитель в РФ: *Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика», 119311, г.
Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт
Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел.: +7 (495) 647-27-40;
E-mail: info@biochemmack.ru
Веб-сайт: www.biochemmack.ru*

Регистрационное № _____ от _____
удостоверение

Символы, применяемые при маркировке медицинского изделия, указаны на оригинальной упаковке. Наименование изделия на настоящем стикере считается приоритетным на территории Российской Федерации

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

Генеральный директор
АО «БиоХимМак»
Черноглазов В.М.

