

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система для выявления антител к отдельным
антигенам возбудителя сифилиса методом
иммунного блоттинга с использованием
рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Комплект №1/1

Состав набора

Иммунсорбент

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Конъюгат

РРО

СР

ПР(х10)

Фотография референс-стрипа

Пинцет пластиковый

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8-ю канавками 3 шт.

Клейкая пленка для планшетов 3 шт.

Комплект рассчитан
на 24 определения,
включая контрольные

24 стрипа

1 фл. (0,2 мл)

1 фл. (0,2 мл)

1 фл. (45 мл)

1 фл. (30 мл)

1 фл. (45 мл)

1 фл. (50 мл)

1 шт.

1 шт.



НВвAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

РРО

с. 07

Годен до 2021.09

30 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Конъюгат

с. 07

Годен до 2021.09

45 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

ПР (х10)

с. 07

Годен до 2021.09

50 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

СР

с. 07

Годен до 2021.09

45 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

К+

с. 07

Годен до 2021.09

0,2 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

К-

с. 07

Годен до 2021.09

0,2 мл



Для профессионального применения

Лайн-Блот Сифилис

ТУ 9398-118-70423725-2020

РУ № РЗН 2014/1657 от 26.04.2018

Лайн-Блот Сифилис IgG

Комплект № 1/1 Каталогный № 03.22.1/1

Серия 07 Контрольный № 156

Дата изготовления: 2020.03.26

Годен до: 2021.09.26



03.22.1/1

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Иммунсорбент

с. 07 Годен до 2021.09

24 стрипа



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.



реактивов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система для выявления антител к отдельным
антигенам возбудителя сифилиса методом
иммунного блоттинга с использованием
рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Комплект №1/2

Состав набора

Комплект рассчитан
на 36 определений,
включая контрольные

Иммунсорбент

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Конъюгат

РРО

СР

ПР(х10)

Фотография референс-стрипа

Пинцет пластиковый

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8-ю канавками 4 шт.

Клейкая пленка для планшетов 4 шт.

36 стрипов

1 фл. (0,2 мл)

1 фл. (0,2 мл)

2 фл. (40 мл)

1 фл. (45 мл)

4 фл. (20 мл)

2 фл. (40 мл)

1 шт.

1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис

ТУ 9398-118-70423725-2020

РУ № РЗН 2014/1657 от 26.04.2018

Лайн-Блот Сифилис IgG

Комплект № 1/2 Каталогный № 03.22.1/2

Серия 02 Контрольный № 149

Дата изготовления: 2020.03.26

Годен до: 2021.09.26



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Иммунсорбент

36 стрипов

с. 02 Годен до 2021.09



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020



Лайн-Блот Сифилис-IgG

РРО

с. 02 45 мл

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Годен до 2021.09

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.



для лабораторий

для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система для выявления антител к отдельным антигенам возбудителя сифилиса методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Комплект №1/3

Состав набора

Иммуносорбент

K+, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

РРО

СР

ПР(х10)

Фотография референс-стрипа

Пинцет пластиковый

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8-ю канавками

Клейкая пленка для планшетов

48 стрипа

1 фл. (0,2 мл)

1 фл. (0,2 мл)

2 фл. (45 мл)

2 фл. (30 мл)

2 фл. (45 мл)

2 фл. (50 мл)

1 шт.

1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

Лайн-Блот Сифилис

ТУ 9398-118-70423725-2020

РУ № РЗН 2014/1657 от 26.04.2018

Лайн-Блот Сифилис IgG

Комплект № 1/3 Каталожный № 03.22.1/3


Серия 09 Контрольный № 158

Дата изготовления: 2020.03.27

Годен до: 2021.09.27



03.22.1/3

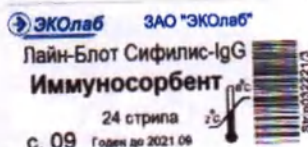







УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

20.09.20



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.



Лайн-Блот Сифилис

Тест-система для выявления антител к отдельным антигенам возбудителя сифилиса методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис-IgM

Комплект №2/1

Комплект рассчитан на 24 определения

Состав набора

Иммунсорбент	24 стрипа
Конъюгат	1 фл. (45 мл)
РФ-сорбент	1 фл. (2мл)
РРО	1 фл. (30 мл)
СР	1 фл. (45 мл)
ПР(х10)	1 фл. (50 мл)
Фотография референс-стрипа	1 шт.
Пинцет пластиковый	1 шт.
Принадлежности:	
Планшет пластмассовый с 8-ю канавками	3 шт.
Клейкая пленка для планшетов	3 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

Лайн-Блот Сифилис

ТУ 9398-118-70423725-2020

РУ № РЗН 2014/1657 от 26.04.2018








Лайн-Блот Сифилис IgM

Комплект № 2/1 Каталогный № 03.22.2/1

Серия 10 Контрольный № 159

Дата изготовления: 2020.03.27

Годеи до: 2021.09.27

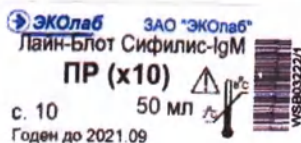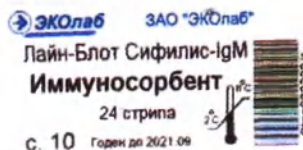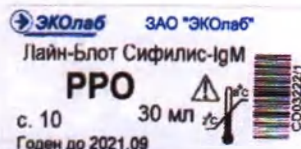

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.



Лайн-Блот Сифилис

Тест-система для выявления антител к отдельным антигенам возбудителя сифилиса методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис-IgM

Комплект №2/2

Состав набора

Иммуносорбент

Конъюгат

РФ-сорбент

РРО

СР

ПР(х10)

Фотография референс-стрипа

Пинцет пластиковый

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8-ю канавками

Клейкая пленка для планшетов

36 стрипов

2 фл. (40 мл)

1 фл. (4 мл)

1 фл. (45 мл)

4 фл. (20 мл)

2 фл. (40 мл)

1 шт.

1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

Лайн-Блот Сифилис

ТУ 9398-118-70423725-2020

РУ № РЭН 14/1657 от 26.04.2018

Лайн-Блот Сифилис IgM

Комплект № 2/2 Каталогный № 03.22.2/2

Серия 05 Контрольный № 152

Дата изготовления: 2020.03.26

Годен до: 2021.09.26

ЗАО "ЭКОлаб"


Лайн-Блот Сифилис-IgM

РРО

с. 05

45 мл

Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 г.



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

Иммуносорбент

36 стрипов

с. 05

Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

Конъюгат

с. 05

40 мл

Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

ПР (х10)

с. 05

40 мл

Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

СР

с. 05

20 мл

Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

РФ-сорбент

с. 05

4 мл

Годен до 2021.09



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.



реактивов

для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис

Тест-система для выявления антител к отдельным антигенам возбудителя сифилиса методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис-IgM

Комплект №2/3

Состав набора

Иммуносорбент

Конъюгат

РФ-сорбент

РРО

СР

ПР(х10)

Фотография референс-стрипа

Пинцет пластиковый

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8-ю канавками

Клейкая пленка для планшетов

48 стрипов

2 фл. (45 мл)

1 фл. (5 мл)

2 фл. (30 мл)

2 фл. (45 мл)

2 фл. (50 мл)

1 шт.

1 шт.

5 шт.

5 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис

ТУ 9398-118-70423725-2020

РУ № РЗН 2014/1657 от 26.04.2018

Лайн-Блот Сифилис IgM

Комплект № 2/3 Каталожный № 03.22.2/3

Серия 06 Контрольный № 153

Дата изготовления: 2020.03.26

Годен до: 2021.09.26



03.22.2/3

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

РРО

с. 06 30 мл
Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

СР

с. 06 45 мл
Годен до 2021.09



ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис-IgM

РФ-сорбент

с. 06 5 мл
Годен до 2021.09



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

« 11 » 01 2020 г.

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.
10 2021 г.








Фотографические изображения общего вида


Набора реагентов «Тест-система для выявления антител к отдельным антигенам возбудителя сифилиса методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов» "Лайн-Блот Сифилис".

серия 01, Комплект 1/1 от 2020.03.26

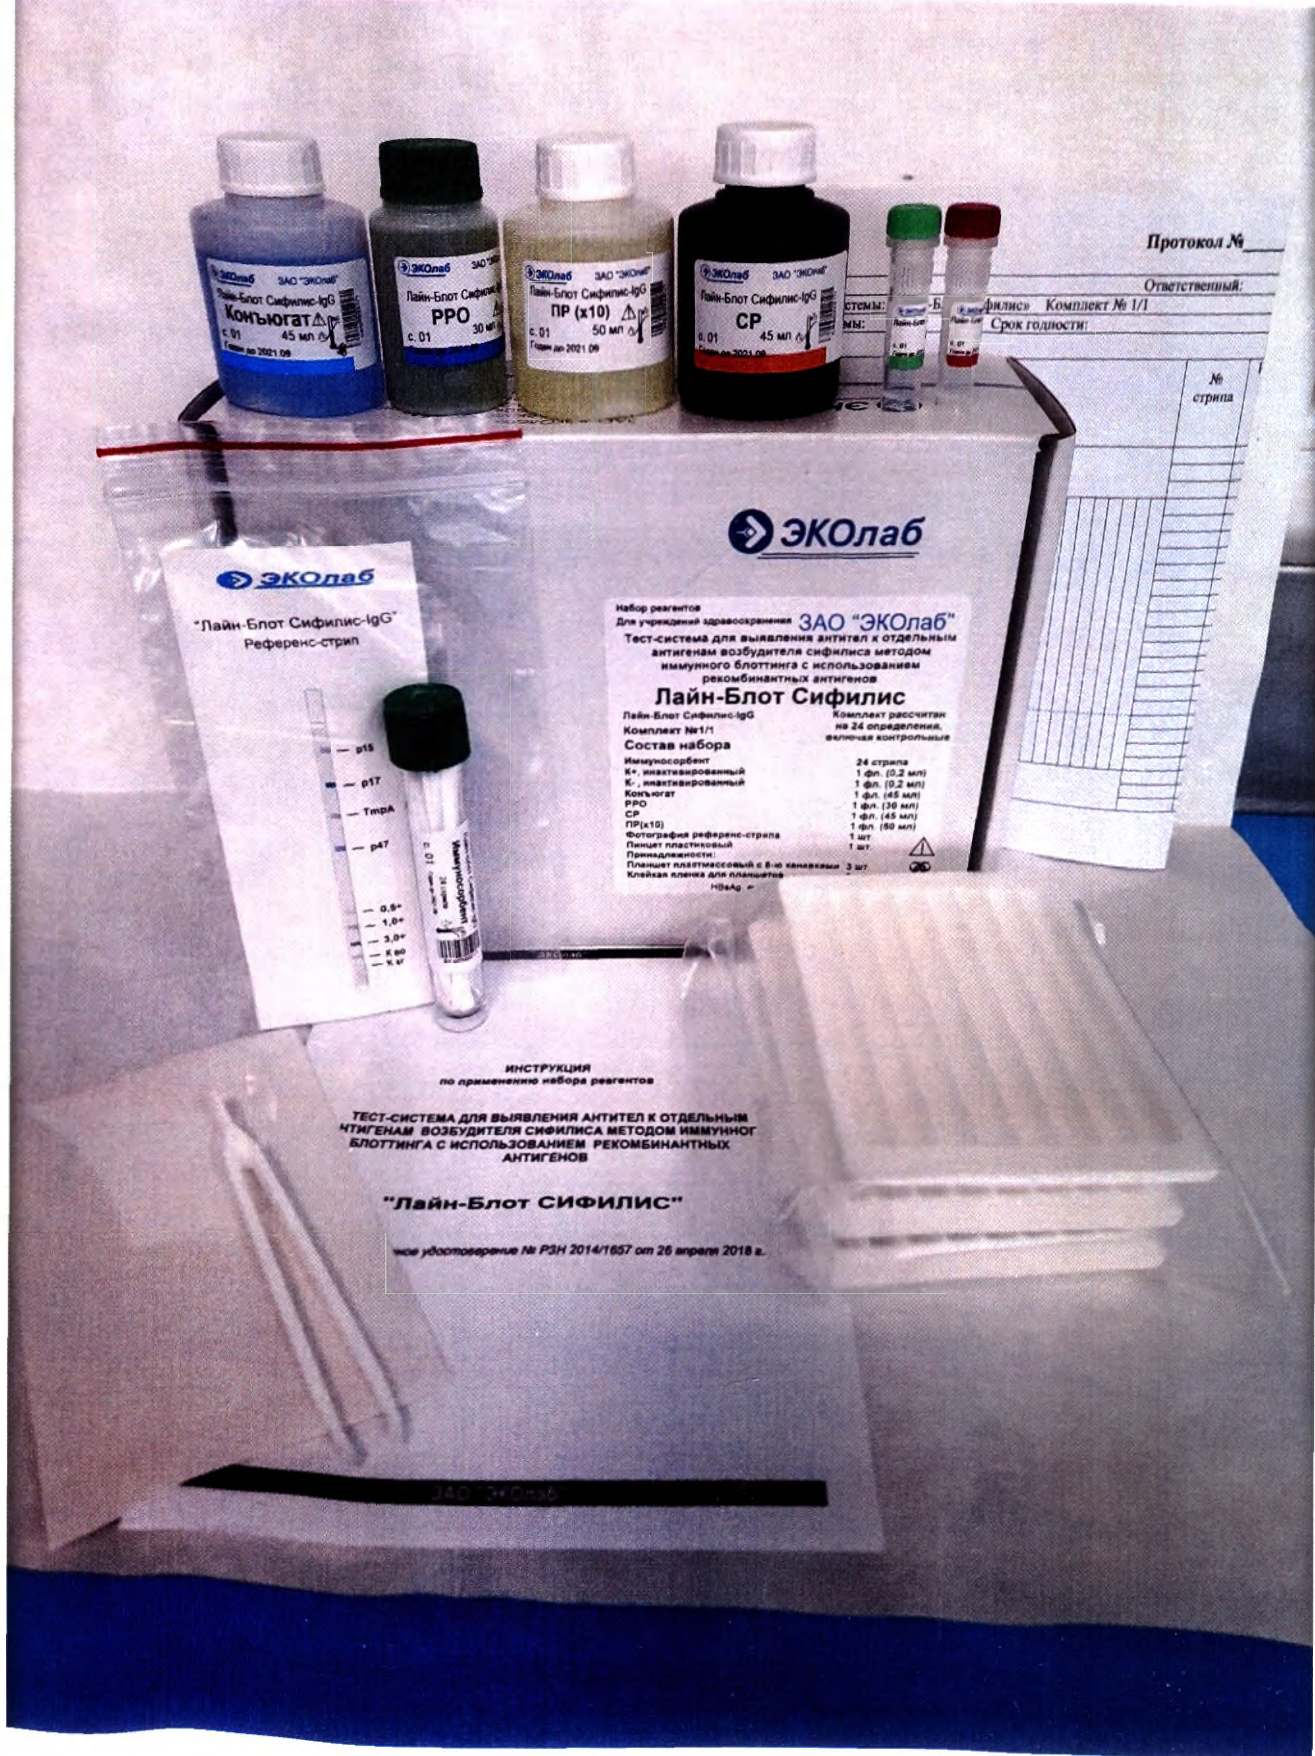

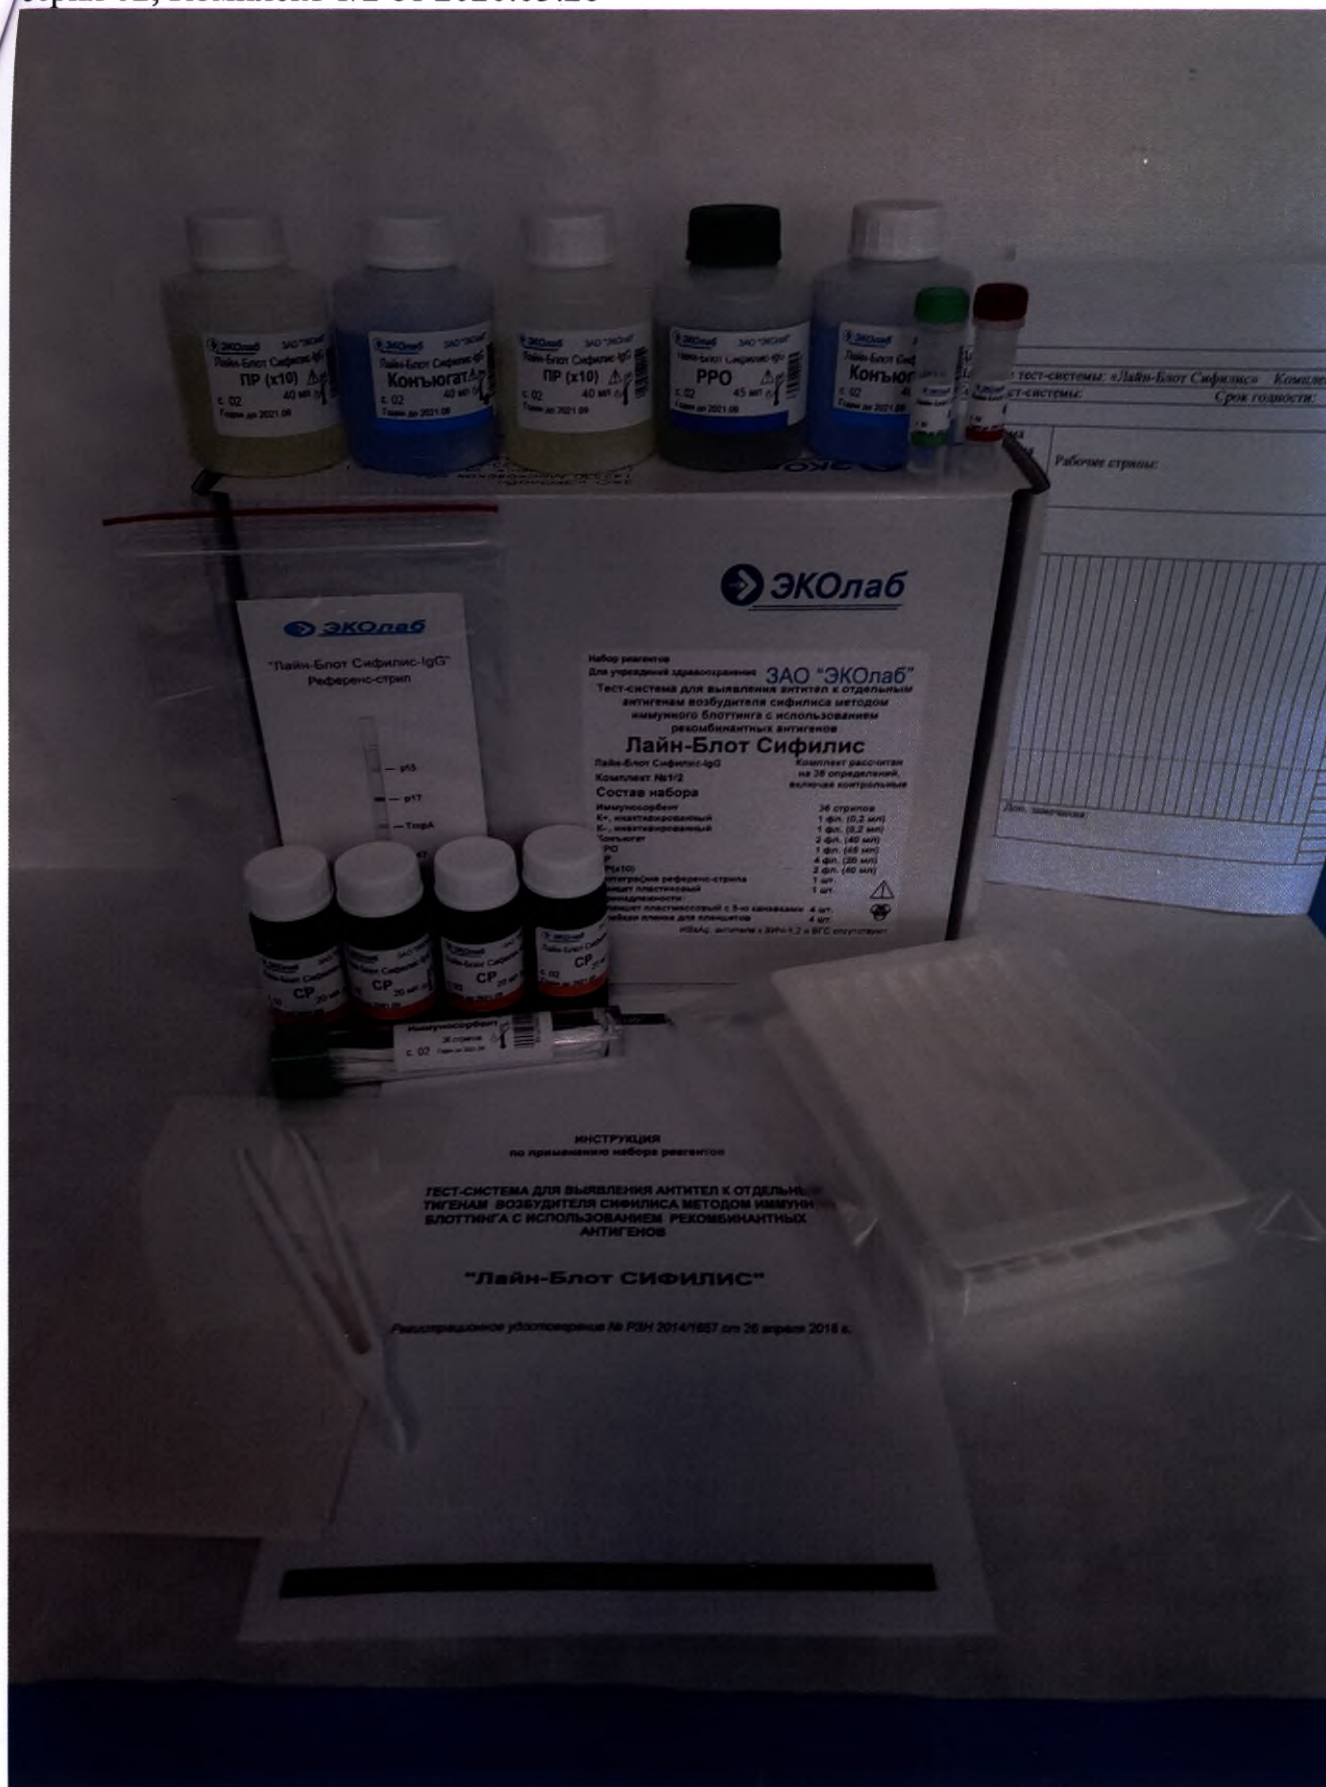

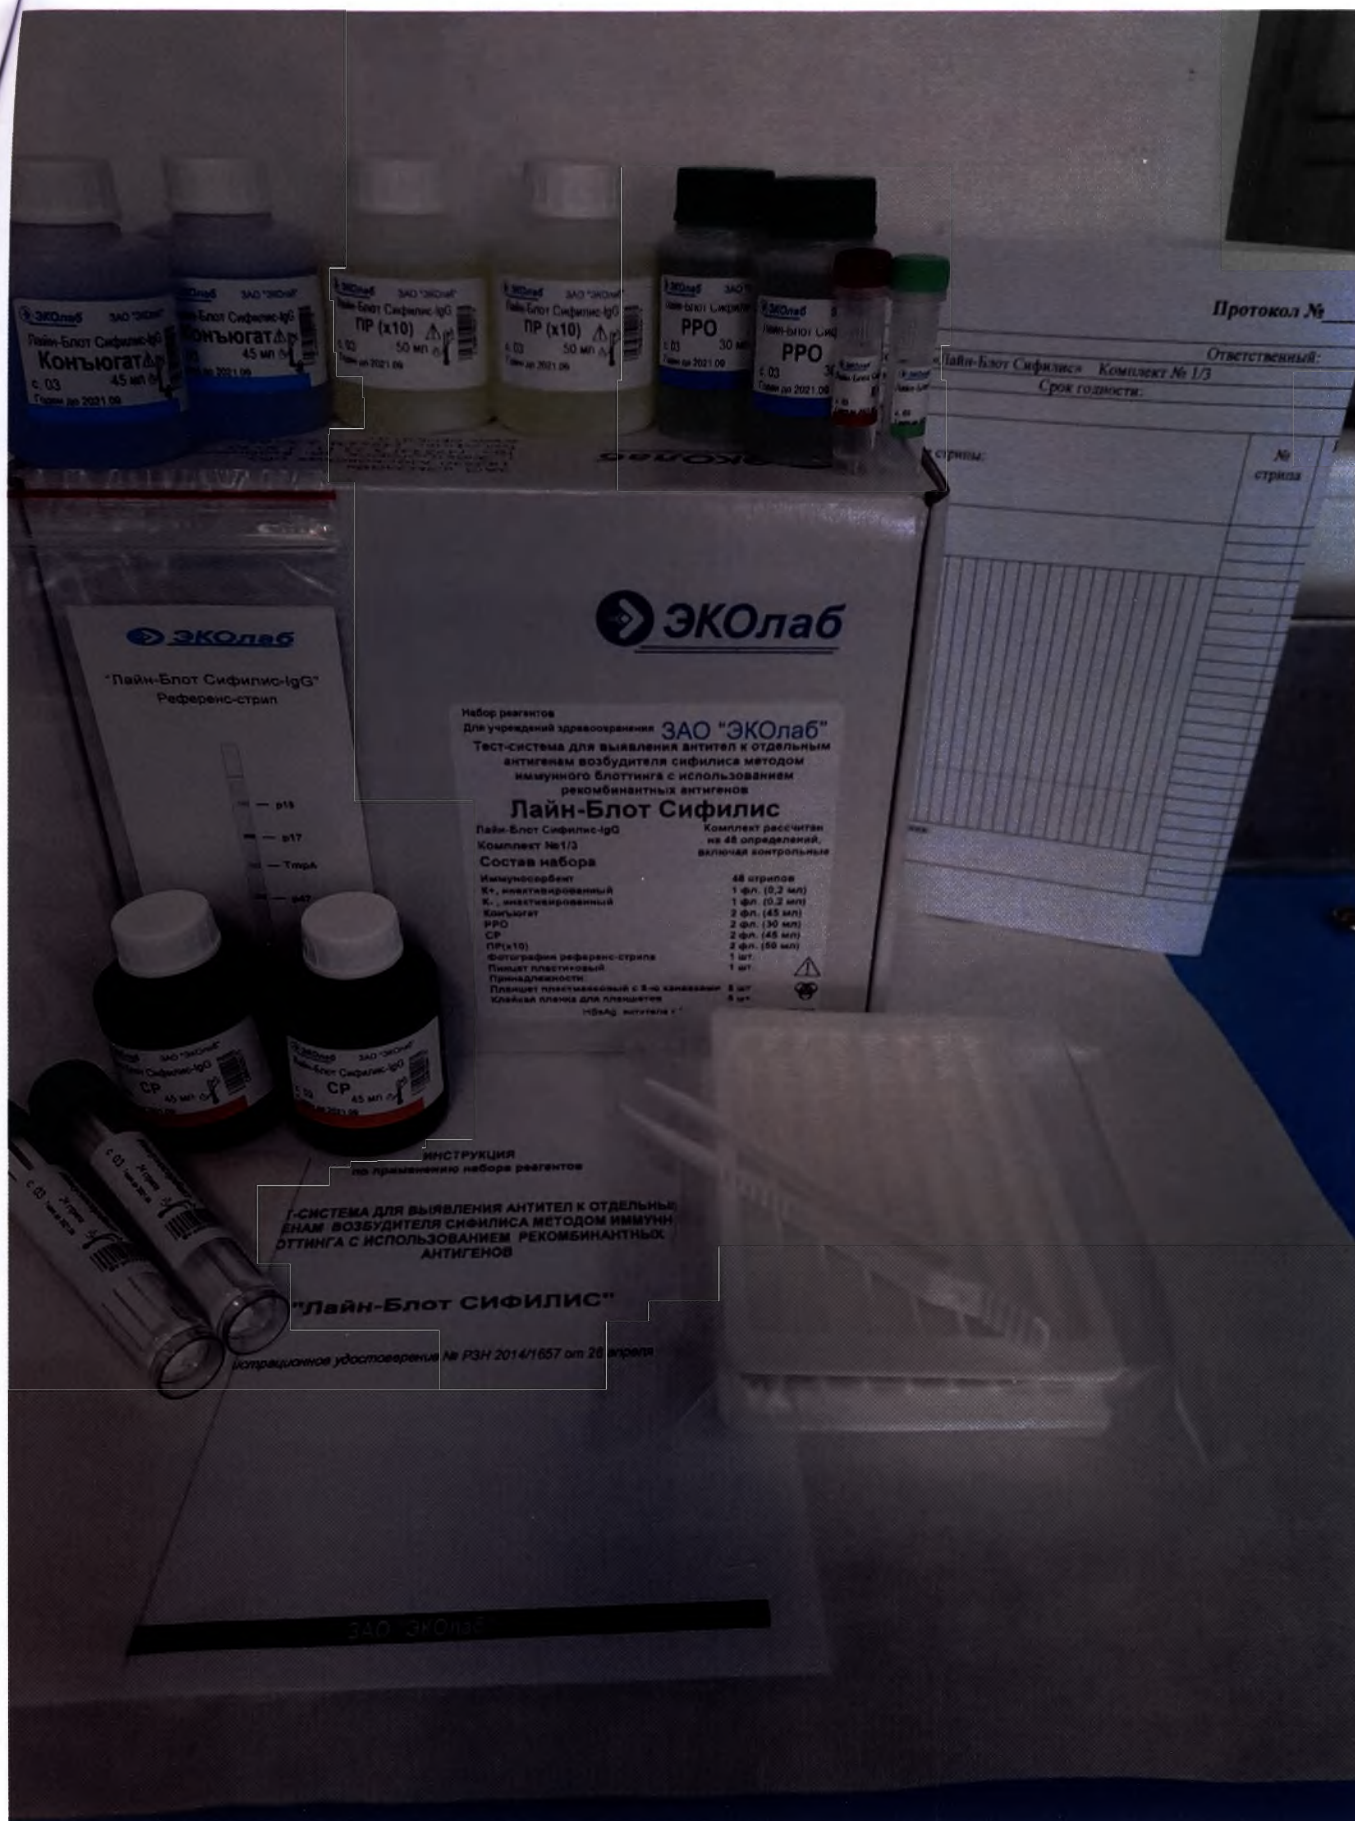

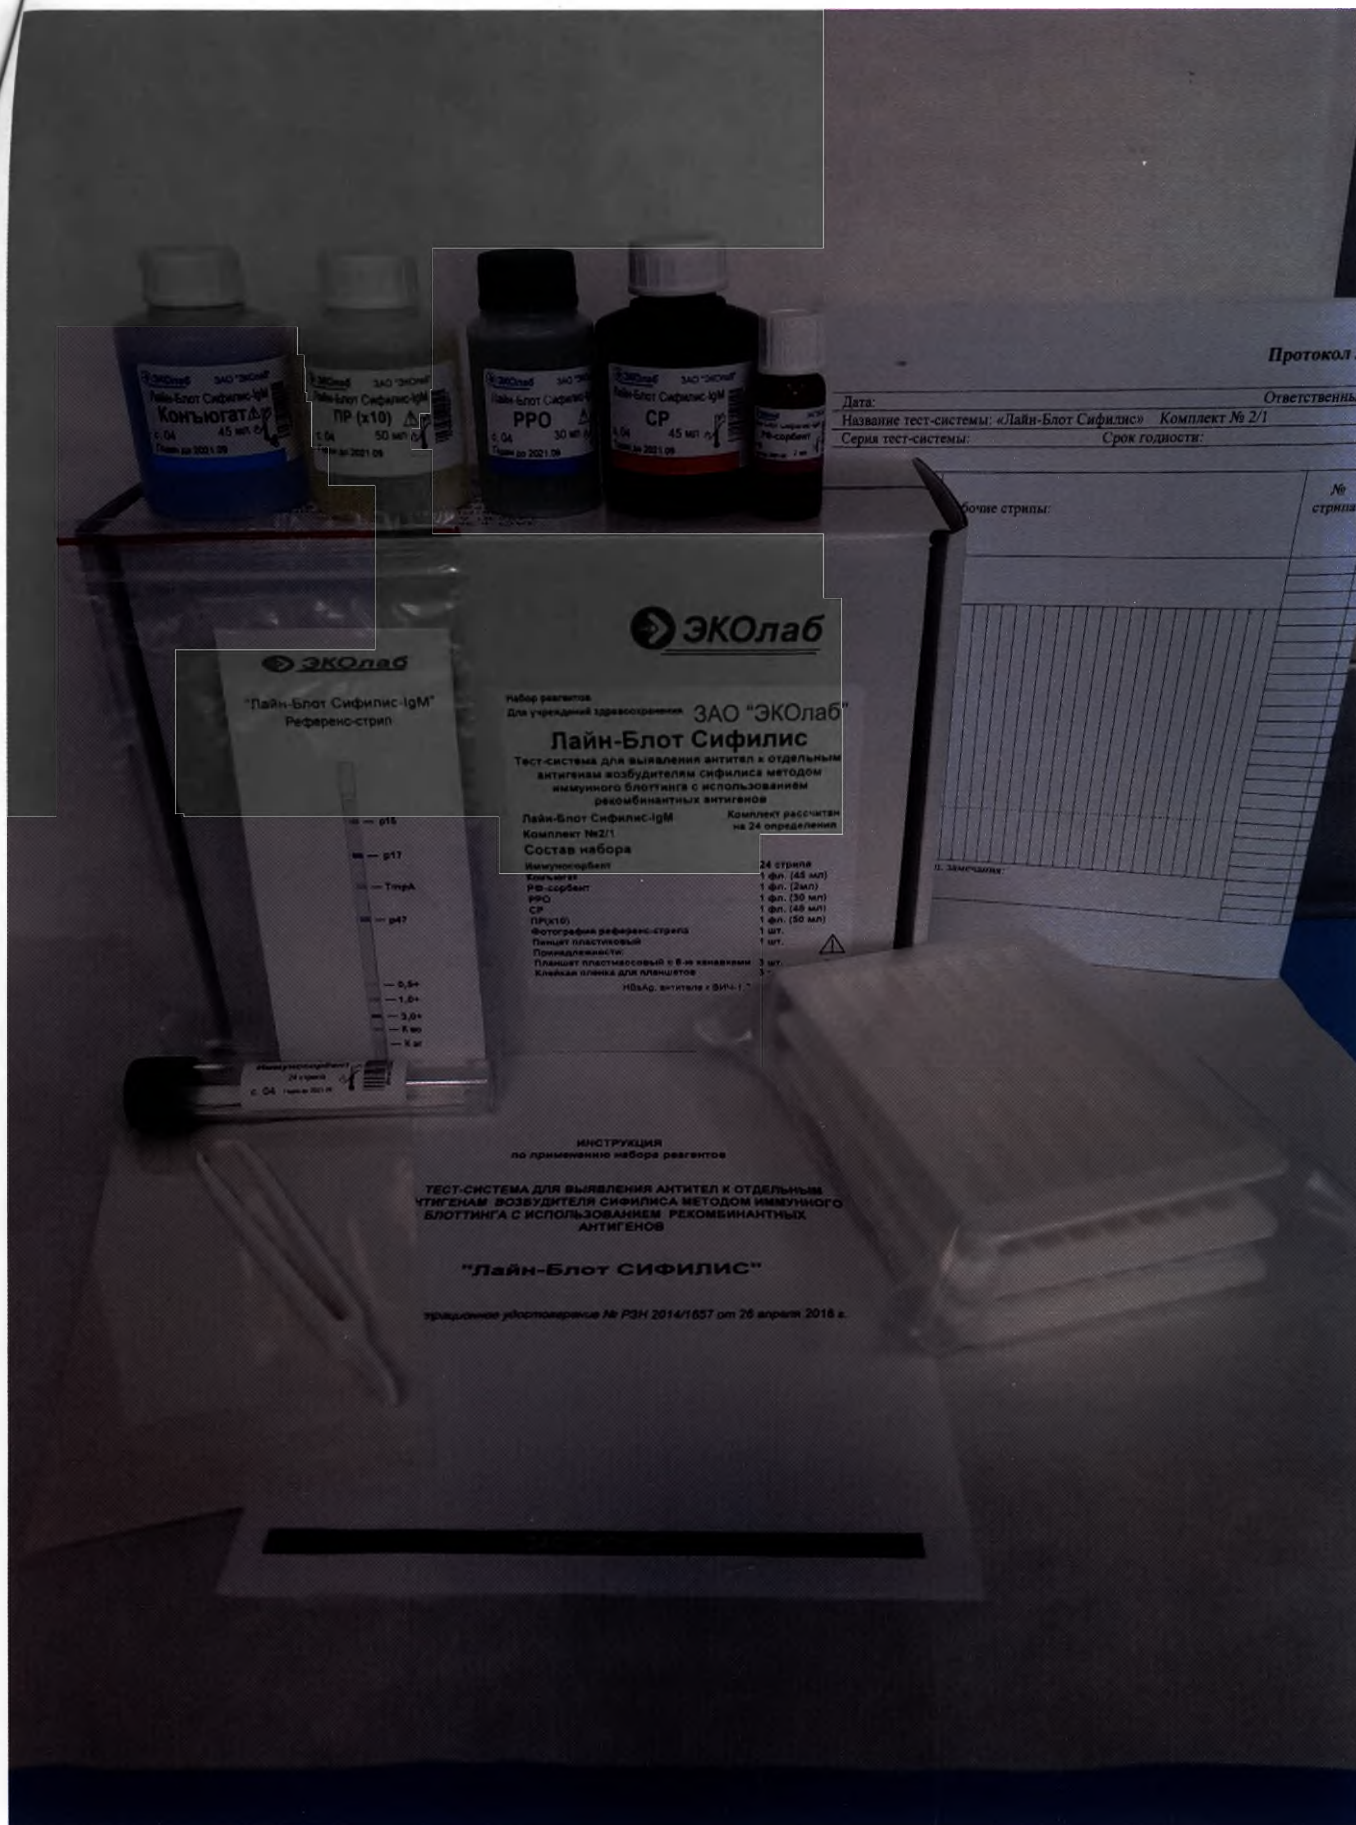

Протокол

Ответственный

Дата: _____
 Название тест-системы: «Лайн-Блот Сифилис» Комплект № 2/1
 Серия тест-системы: _____ Срок годности: _____

бочие стрипы:

№
стрипы

ЭКОлаб

ЭКОлаб

"Лайн-Блот Сифилис-IgM"
Референс-стрип

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот Сифилис

Тест-система для выявления антител к отдельным антигенам возбудителя сифилиса методом иммуноного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис-IgM Комплект №2/1

Состав набора

Иммуноконъюгат	24 стрипы
Конъюгат	1 фл. (45 мл)
PR-субстрат	1 фл. (240 мл)
RPO	1 фл. (30 мл)
CP	1 фл. (40 мл)
PR(x10)	1 фл. (50 мл)
Фотография референс-стрипа	1 шт.
Панель пластиковая	3 шт.
Принадлежности	5 шт.
Планишет пластиковый с 8-ю ячейками	3 шт.
Клейкая пленка для планшетов	5 шт.

ИВЛАД, выдана в 04/04/21


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ОТДЕЛЬНЫМ АНТИГЕНАМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СИФИЛИСА МЕТОДОМ ИММУНОГО БЛОТТИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИГЕНОВ

"Лайн-Блот СИФИЛИС"

традиционное удостоверение № РЗН 2014/1657 от 26 апреля 2016 г.



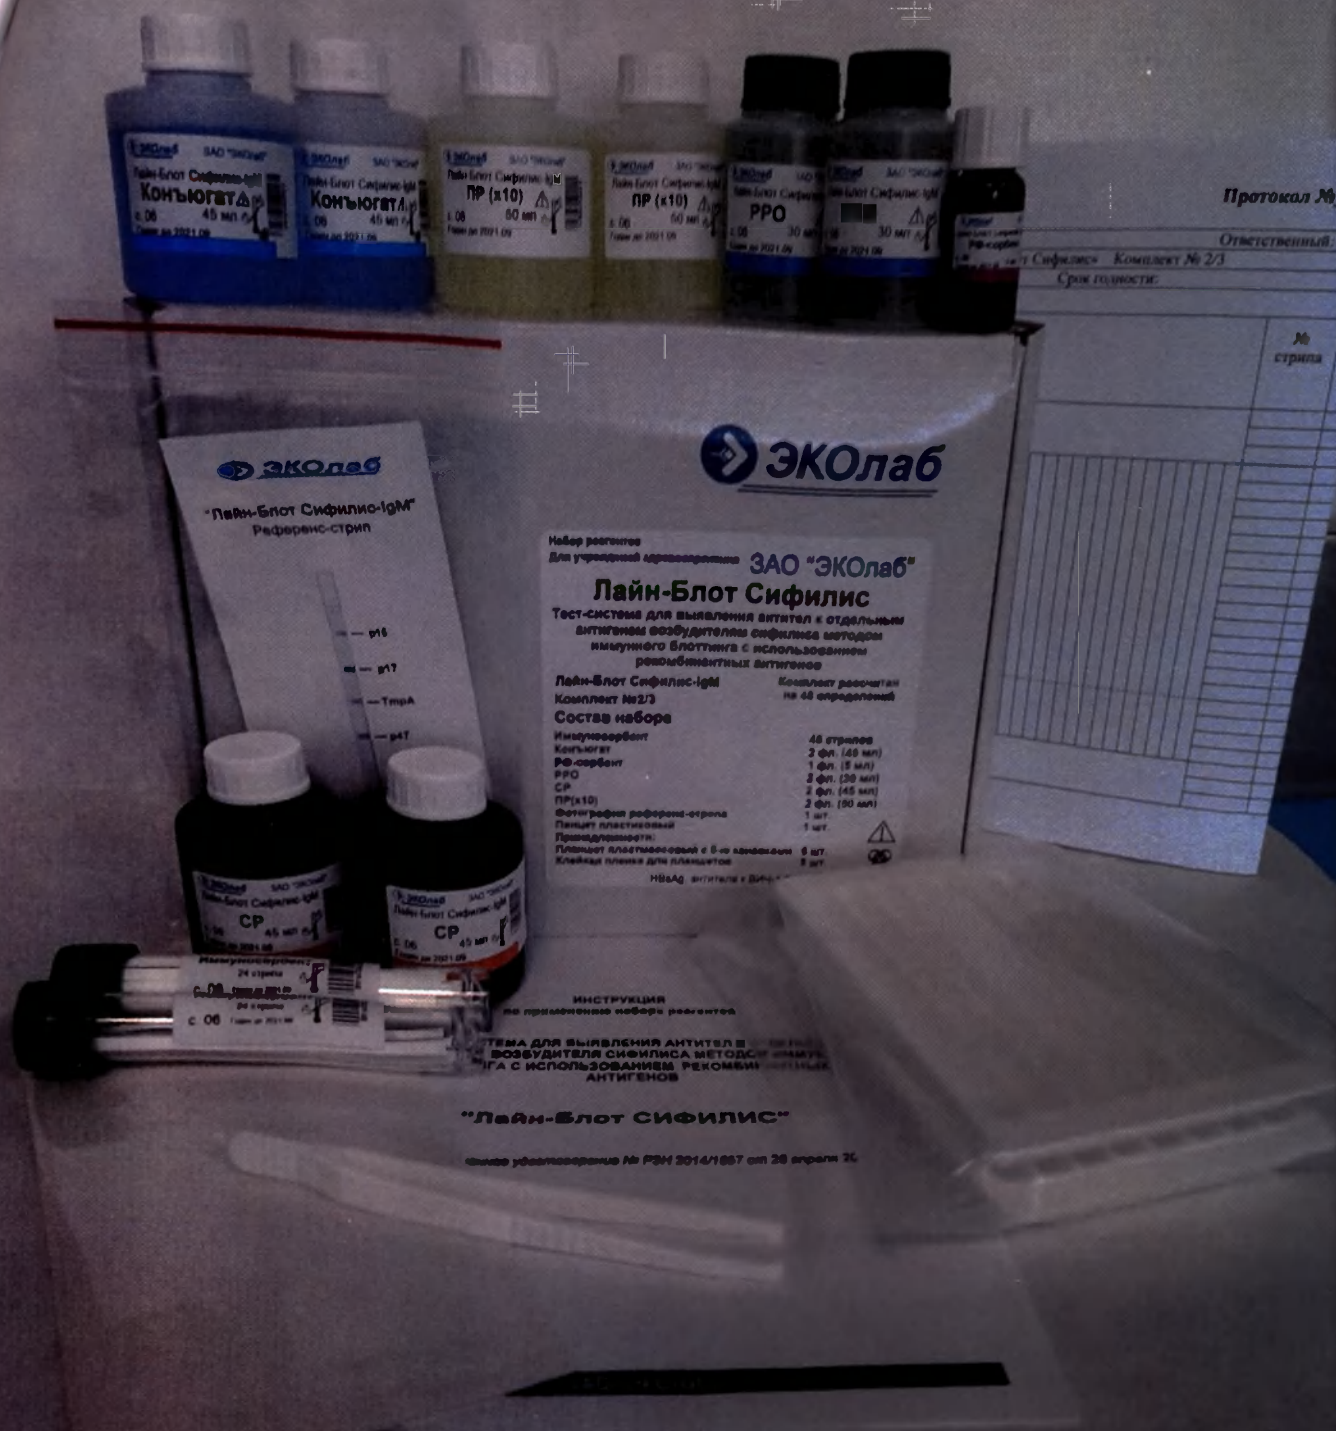





ЭКОлаб
"Лайн-Блот Сифилис-IgG"
Референс-стрип

— p15
— p17
— TmgA



ЭКОлаб

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Тест-система для выявления антител к отдельным
антигенам возбудителя сифилиса методом
иммунного блоттинга с использованием
рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот Сифилис

Лайн-Блот Сифилис-IgG

Комплект №1/2

Состав набора

Иммуносорбент

К+, инaktivированный

К-, инaktivированный

Конъюгат

Комплект рассчитан
на 36 определений,
включая контрольные

36 стрипов
1 фл. (0.2 мл)
1 фл. (0.2 мл)
2 фл. (40 мл)
1 фл. (45 мл)
4 фл. (20 мл)
2 фл. (40 мл)
1 шт.
1 шт.

Линейка референс-стрипов

Пластиковый флакон

Пластиковый флакон с 6-ю канавками

Пленка для планшетов


НБАд, антигены Bln-1,2 и BIC отсутствуют


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов


ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ОТДЕЛЬНЫМ
АНТИГЕНАМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СИФИЛИСА МЕТОДОМ ИММУННОГО
БЛОТТИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНЫХ
АНТИГЕНОВ

"Лайн-Блот СИФИЛИС"

Лицензия на использование № РЗН 2014/1657 от 26 января 2018 г.

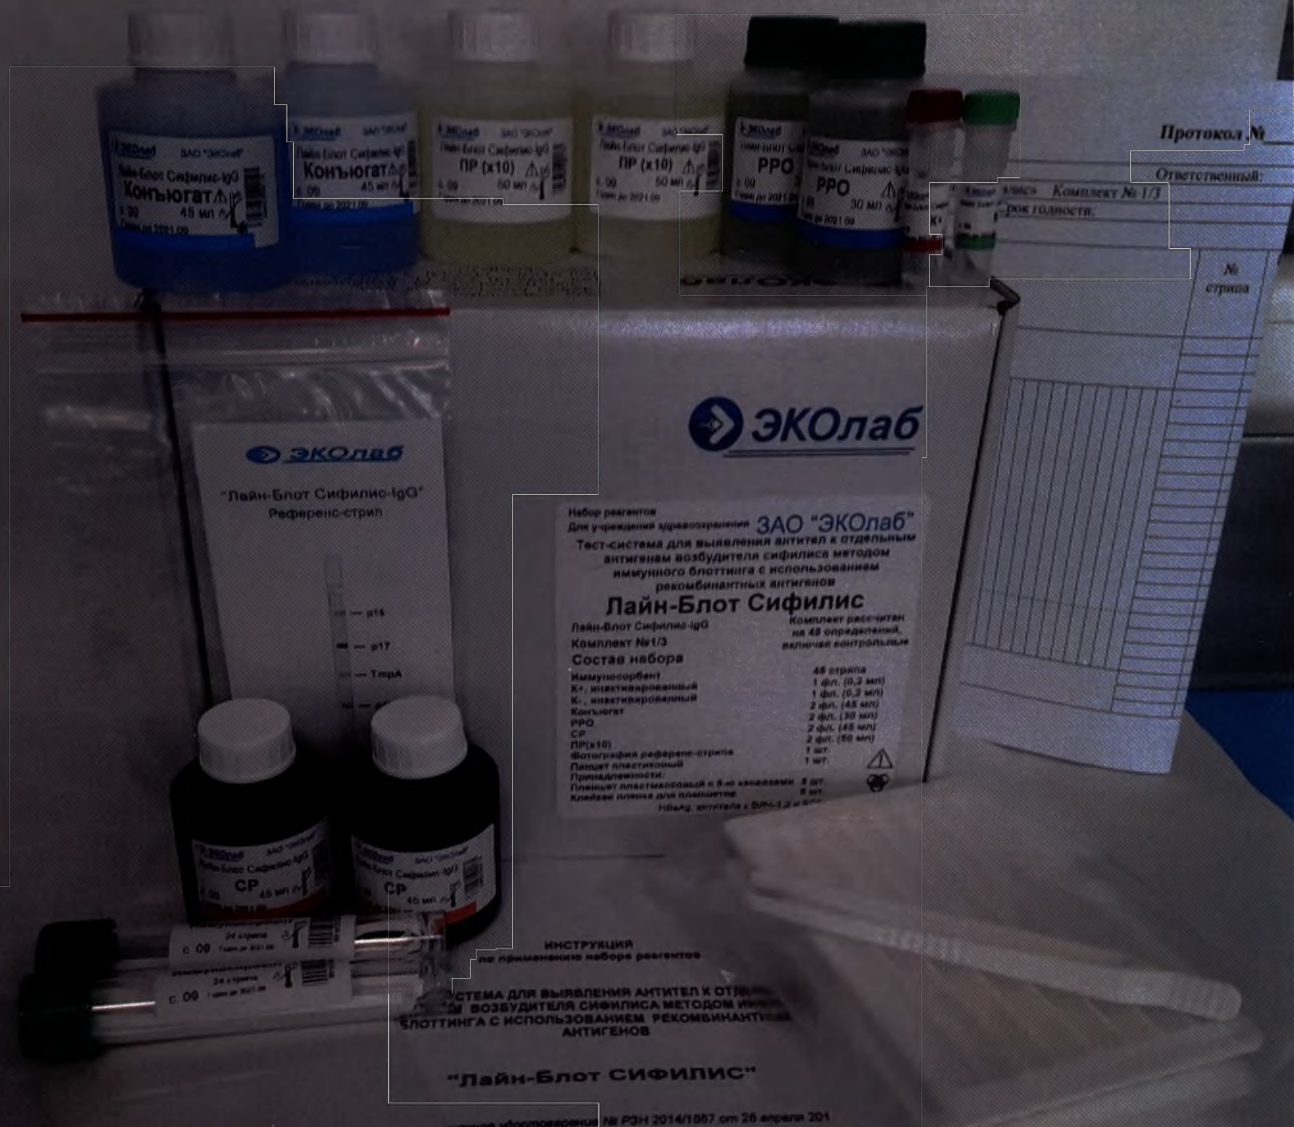

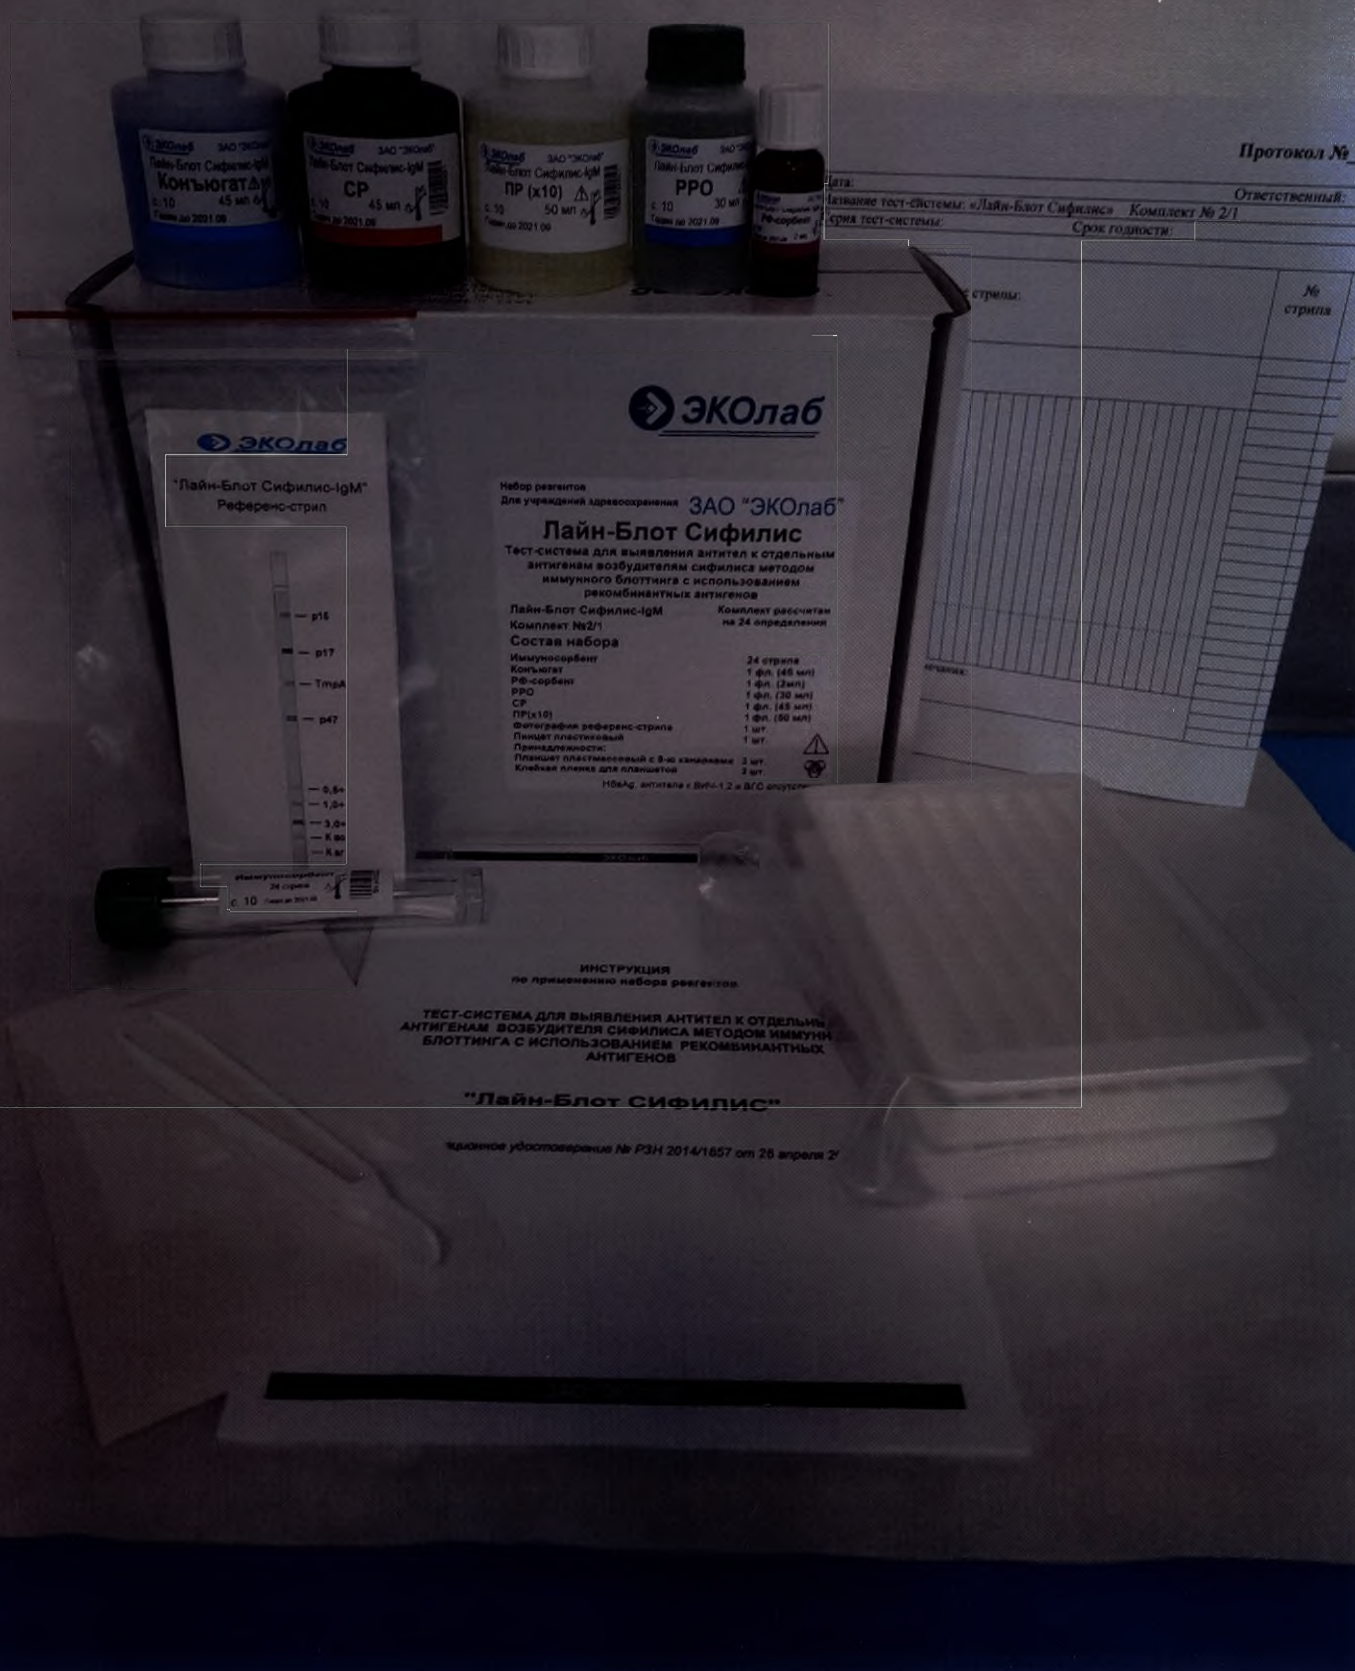

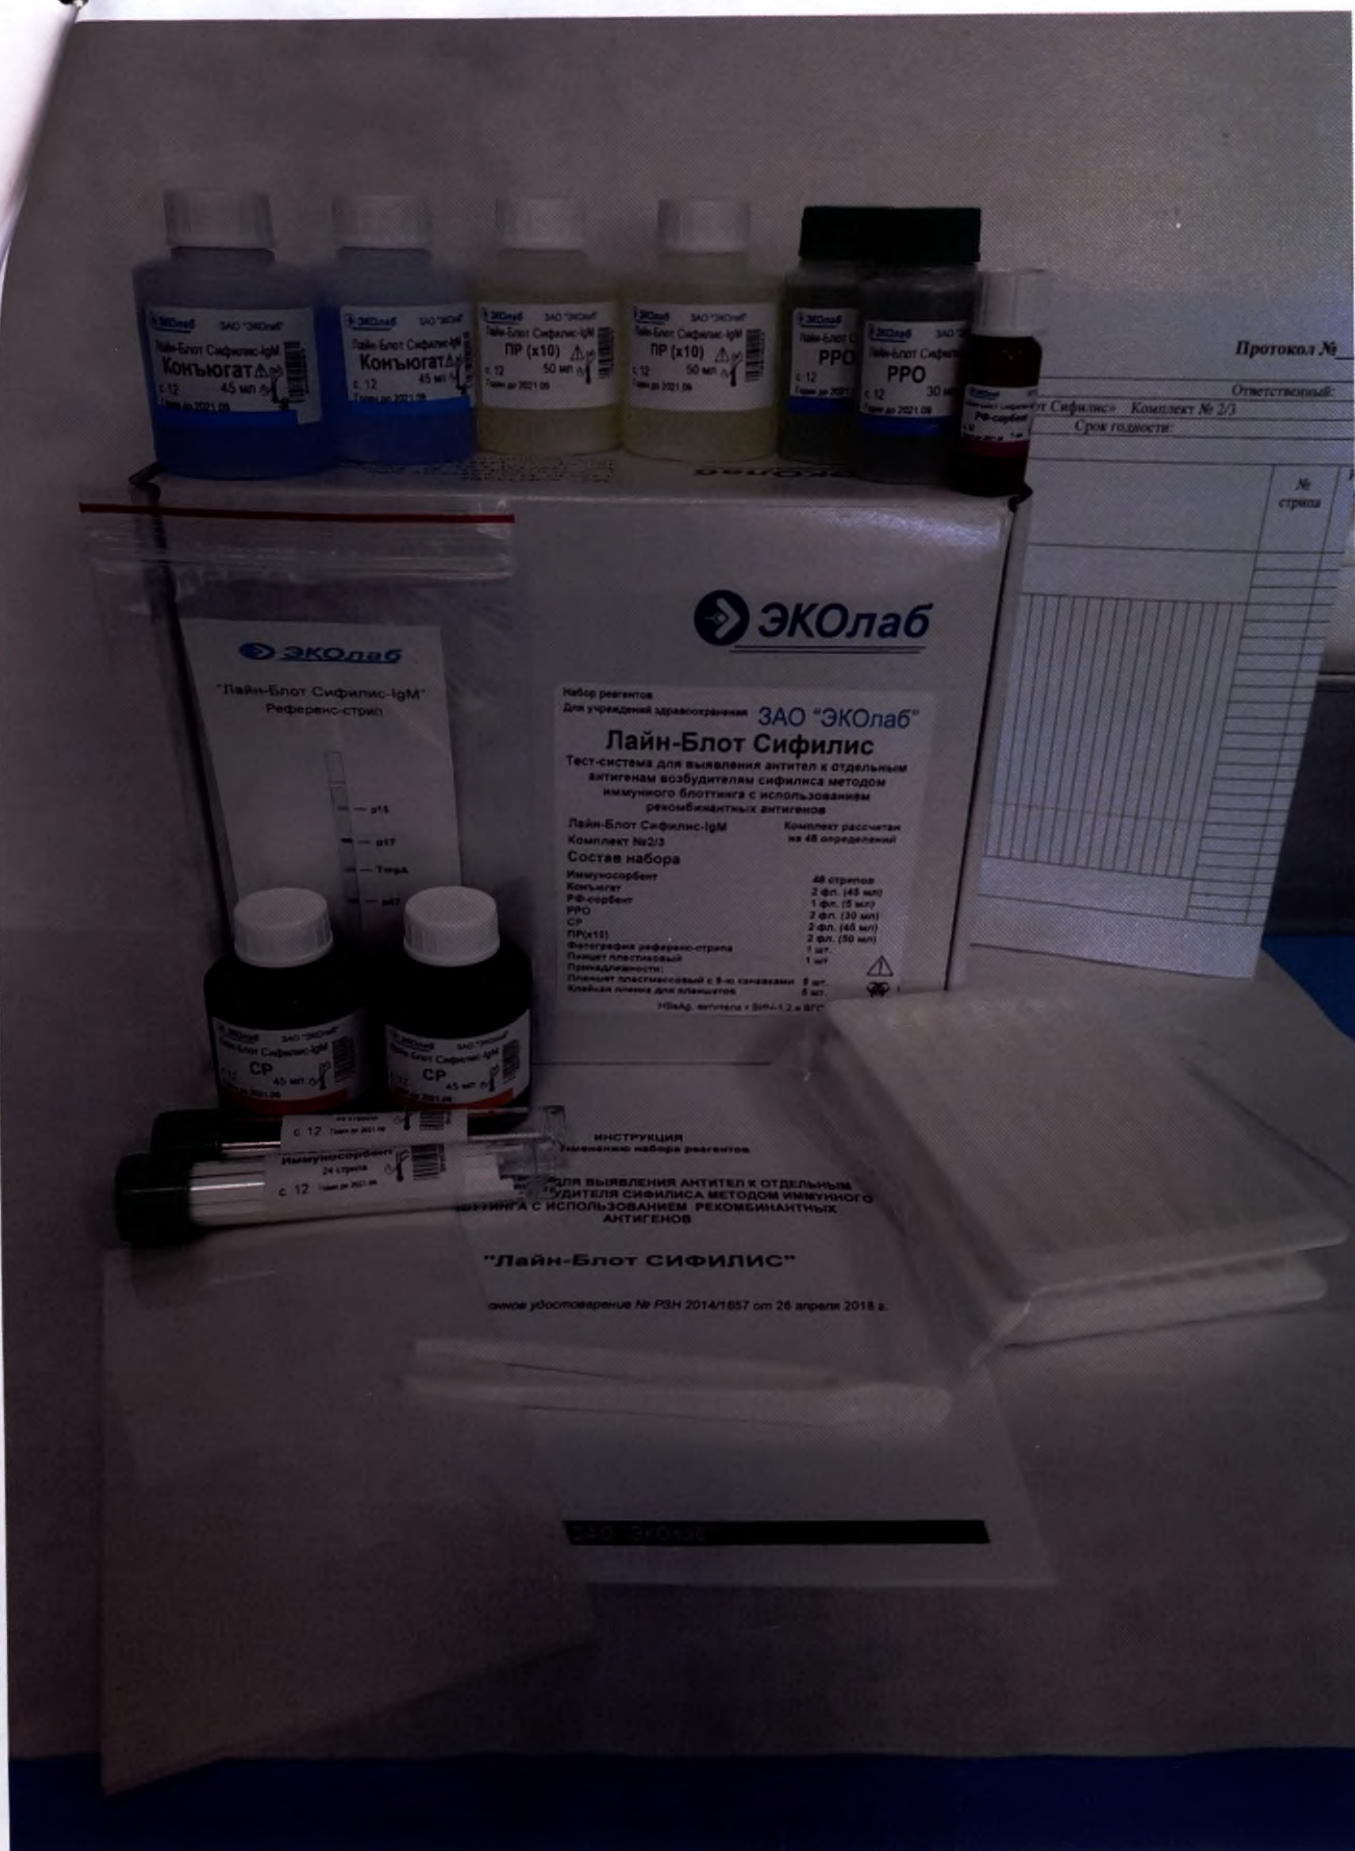

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



В.Ю. Борисов

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.

