

УТВЕРЖДАЮ
Директор

ООО «АльфаМедика»

Р. В. Дорожкин

«15» февраля 2018 г.



Изменения к фотографическим изображениям

общего вида медицинского изделия

**«Имплантаты для остеосинтеза с инструментами для имплантации по
ТУ 32.50.22-005-06980502-2017»**

Сведения о внесенных изменениях

1. Внесены изменения в фото 21,22, 72,73,74, 75,76,77 в части названия;
2. Фото 71 заменено.

Фото 21.

Пластина предизогнутая на наружную лодыжку под винт диаметром 3.5 мм

Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 3 отв. Прямая,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 4 отв. Прямая,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 5 отв. Прямая,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 6 отв. Прямая,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 7 отв. Прямая.

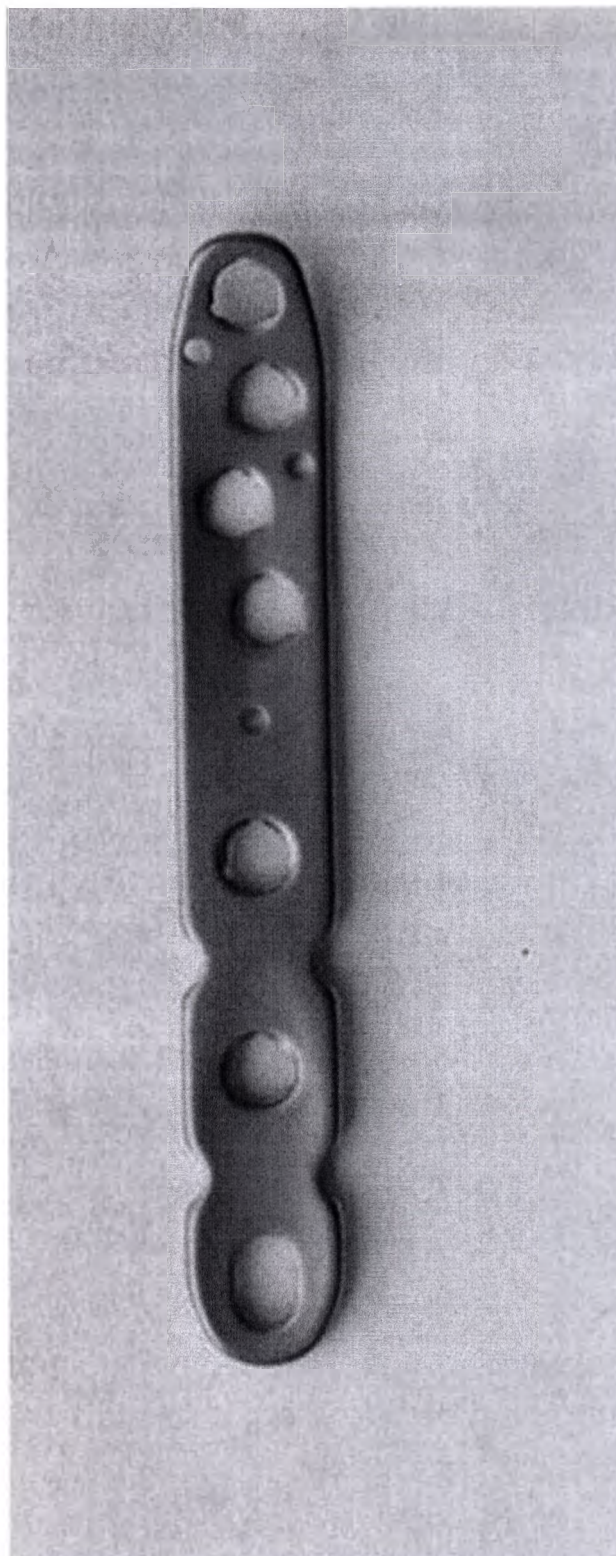


Фото 22 - Пластина предизогнутая на наружную лодыжку под винт
диаметром 3.5 мм (ложка)

Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 3 отв. Ложка,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 4 отв. Ложка,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 5 отв. Ложка,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 6 отв. Ложка,
Пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 7 отв. Ложка.

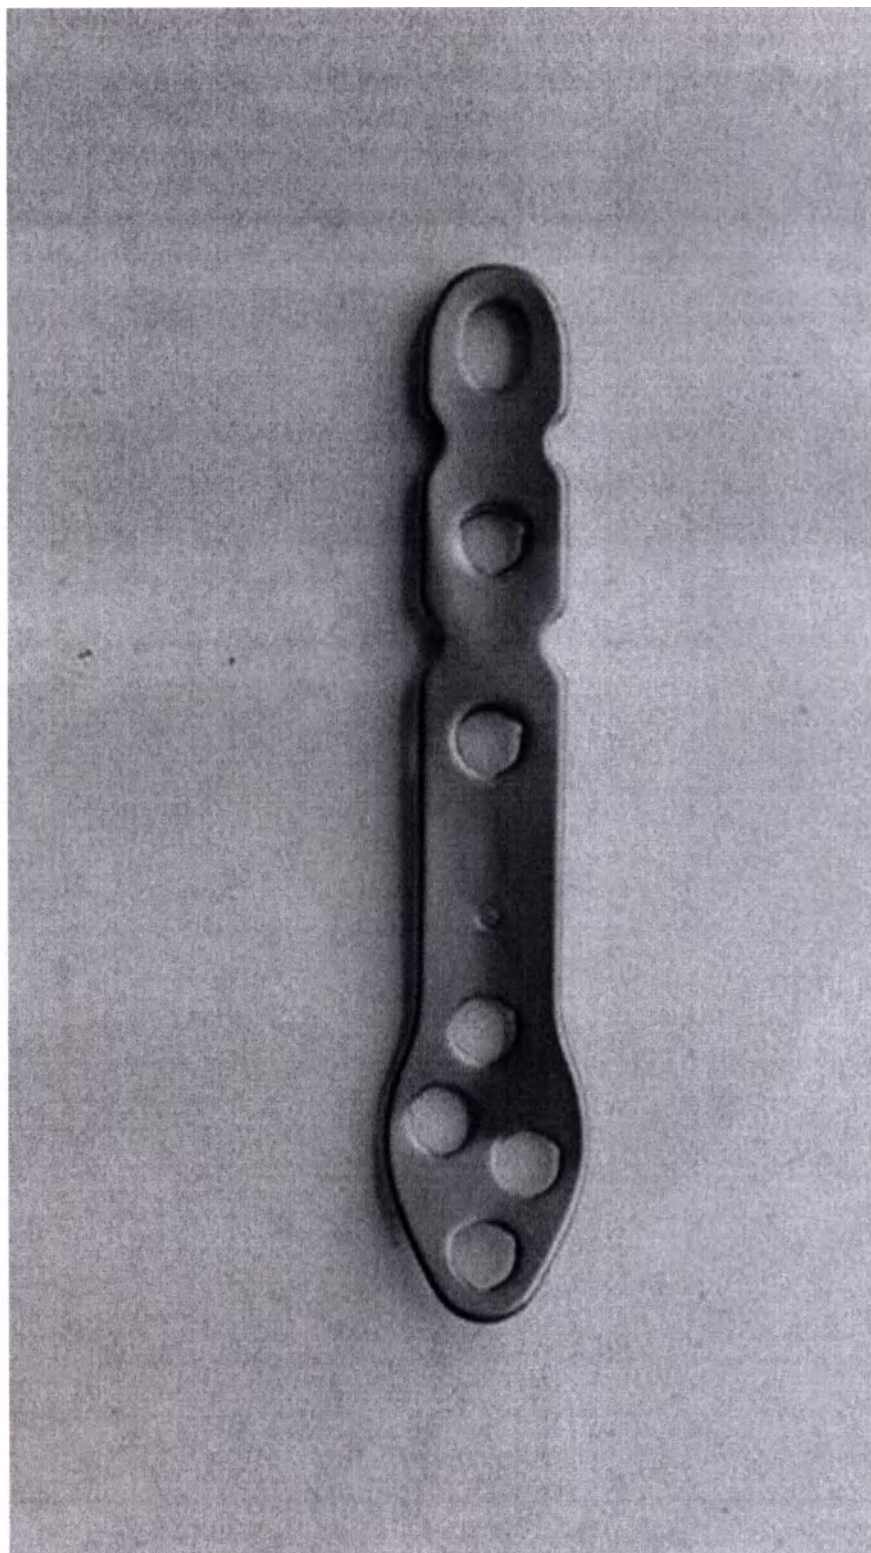


Фото 71 - Проволока

Проволока Ø 0.18мм, длина 144м; Проволока Ø 0.32мм, длина 45м;
Проволока Ø 0.38мм, длина 31.4м; Проволока Ø 0.46мм, длина 21.8м;
Проволока Ø 0.56мм, длина 14.6м; Проволока Ø 0.76мм, длина 7.9м;
Проволока Ø 0.86мм, длина 6.0м; Проволока Ø 1.0мм, длина 4.9м;
Проволока Ø 1.2мм, длина 3.0м



Фото 72 - Винт моноаксиальный диаметром 5.5 мм, 6.5 мм, 7.5 мм для транспедикулярной системы 5.5.

5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50,
6.5x35, 6.5x40, 6.5x45, 6.5x50, 6.5x55,
7.5x35, 7.5x40, 7.5x45, 7.5x50, 7.5x55


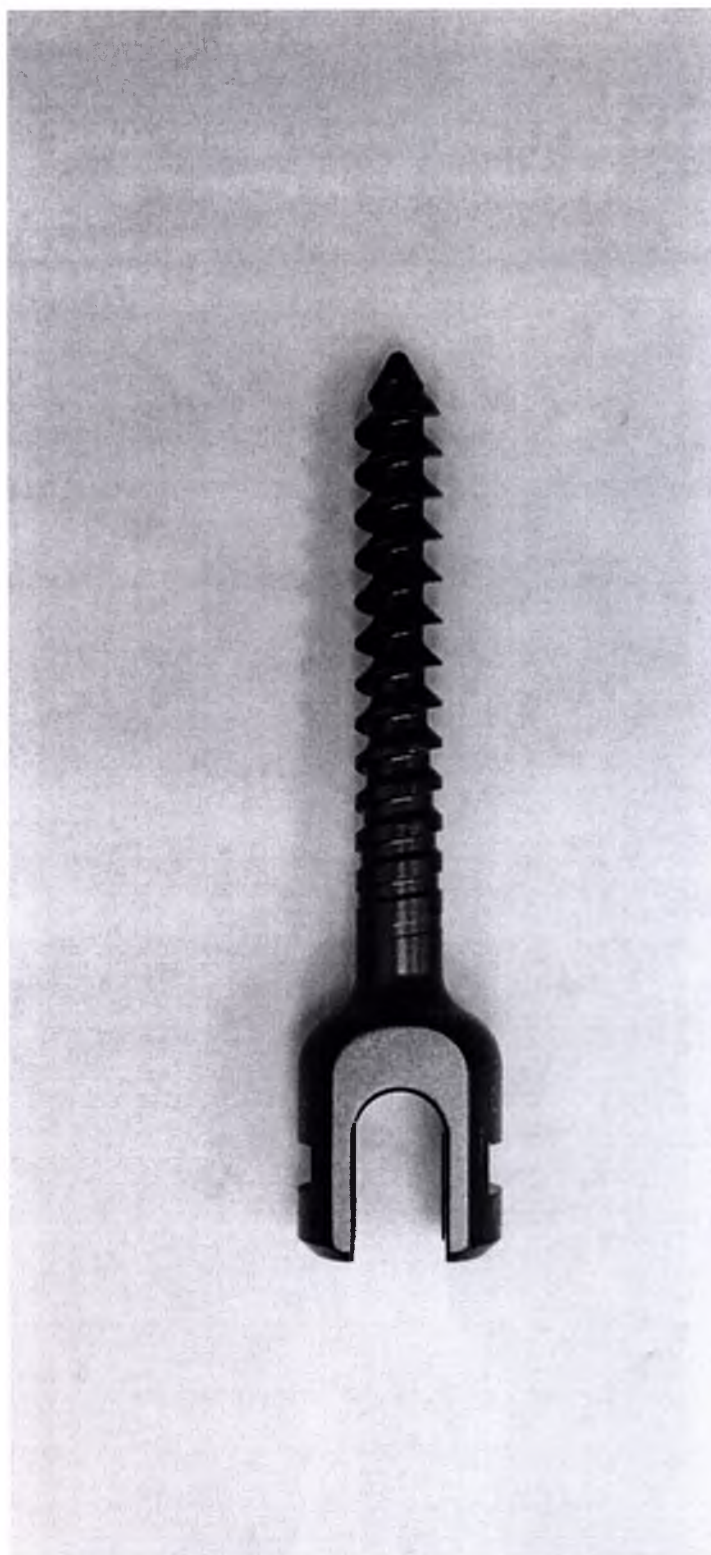


Фото 73 – Винт моноаксиальный диаметром 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.5 мм, 7.5 мм, 8.0 мм, 8.5 мм для транспедикулярной системы 6.0.

4.5x35, 4.5x40, 4.5x45, 4.5x50, 4.5x55,
5.0x35, 5.0x40, 5.0x45, 5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50, 5.5x55, 5.5x60,
6.5x35, 6.5x40, 6.5x45, 6.5x50, 6.5x55,
7.5x35, 7.5x40, 7.5x45, 7.5x50, 7.5x55, 7.5x60,
8.0x35, 8.0x40, 8.0x45, 8.0x50, 8.0x55, 8.0x60,
8.5x35, 8.5x40, 8.5x45, 8.5x50, 8.5x55, 8.5x60

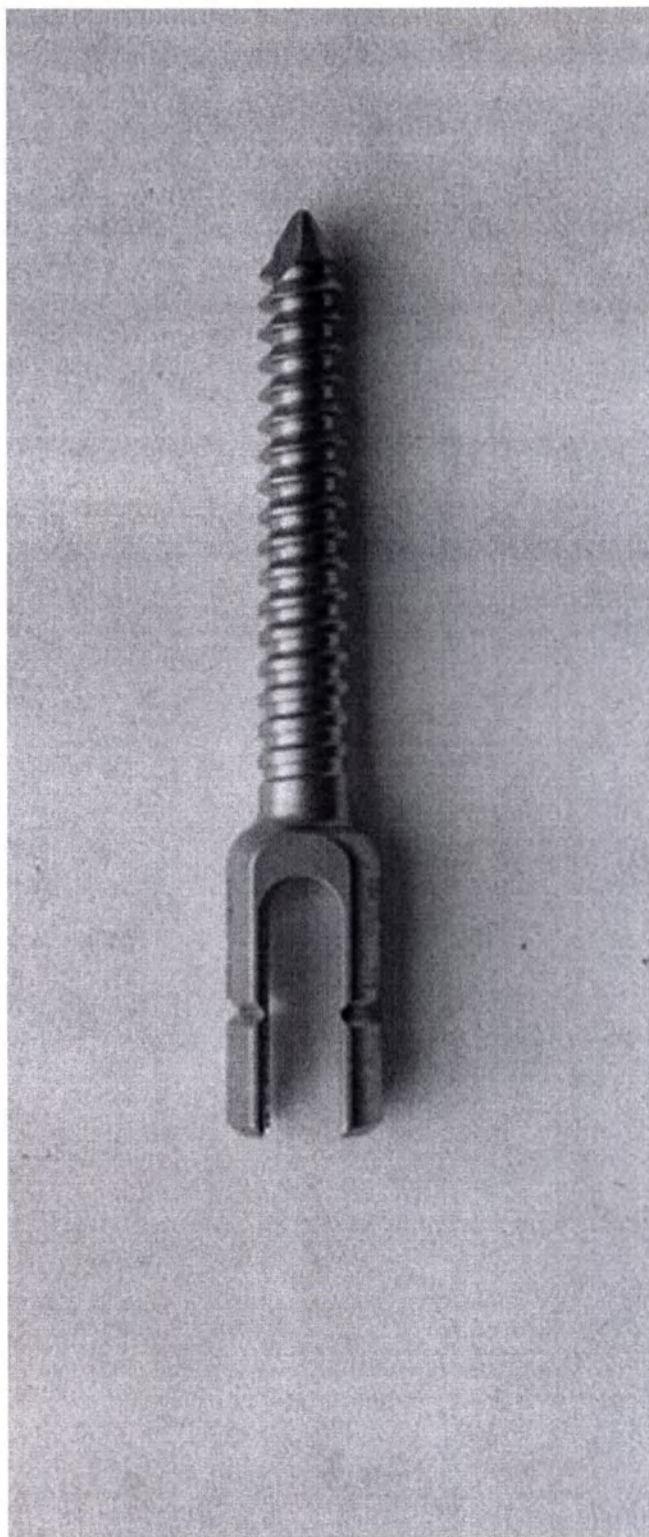

ВИНТЫ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЕ

Фото 74 – Винт полиаксиальный диаметром 5.5 мм, 6.5 мм, 7.5 мм для транспедикулярной системы 5.5.

5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50,
6.5x35, 6.5x40, 6.5x45, 6.5x50, 6.5x55,
7.5x35, 7.5x40, 7.5x45, 7.5x50, 7.5x55



Фото 75 – Винт полиаксиальный диаметром 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.5 мм, 7.5 мм, 8.0 мм, 8.5 мм для транспедикулярной системы 6.0.

4.5x35, 4.5x40, 4.5x45, 4.5x50, 4.5x55,
5.0x35, 5.0x40, 5.0x45,
5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50, 5.5x55, 5.5x60,
6.5x35, 6.5x40, 6.5x45, 6.5x50, 6.5x55,
7.5x35, 7.5x40, 7.5x45, 7.5x50, 7.5x55, 7.5x60,
8.0x35, 8.0x40, 8.0x45, 8.0x50, 8.0x55, 8.0x60,
8.5x35, 8.5x40, 8.5x45, 8.5x50, 8.5x55, 8.5x60

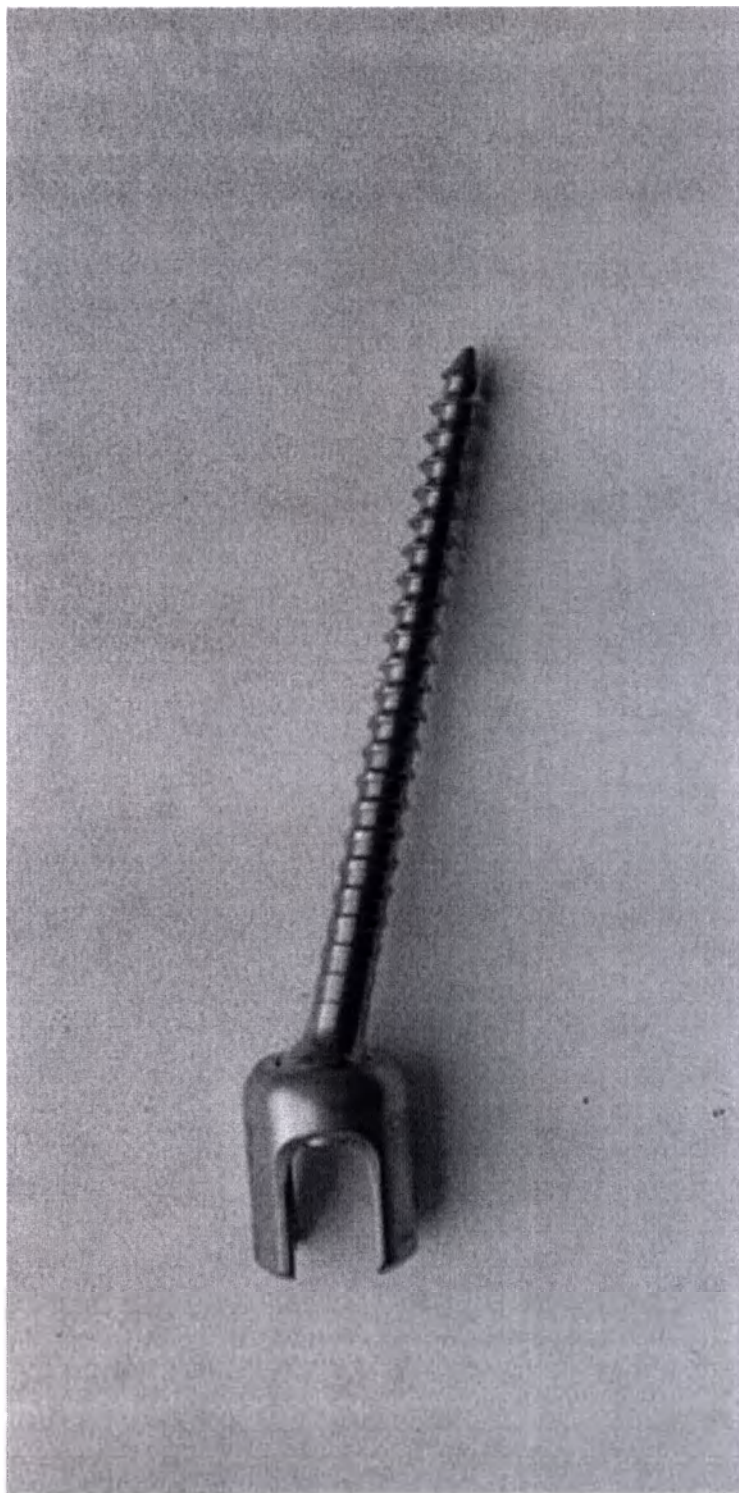



Фото 76 – Винт полиаксиальный репозиционный диаметром 5.5 мм, 6.5 мм, 7.5 мм, для транспедикулярной системы 5.5.

5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50,
6.5x35, 6.5x40, 6.5x45, 6.5x50, 6.5x55,
7.5x35, 7.5x40, 7.5x45, 7.5x50, 7.5x55



Фото 77 – Винт полиаксиальный репозиционный диаметром 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.5 мм, 7.5 мм, 8.0 мм, 8.5 мм для транспедикулярной системы 6.0.

4.5x35, 4.5x40, 4.5x45, 4.5x50, 4.5x55,
5.0x35, 5.0x40, 5.0x45,
5.5x35, 5.5x40, 5.5x45, 5.5x50, 5.5x55, 5.5x60,
6.5x35, 6.5x40, 6.5x45, 6.5x50, 6.5x55, 6.5x60,
7.5x35, 7.5x40, 7.5x45, 7.5x50, 7.5x55, 7.5x60,
8.0x35, 8.0x40, 8.0x45, 8.0x50, 8.0x55, 8.0x60,
8.5x35, 8.5x40, 8.5x45, 8.5x50, 8.5x55, 8.5x60

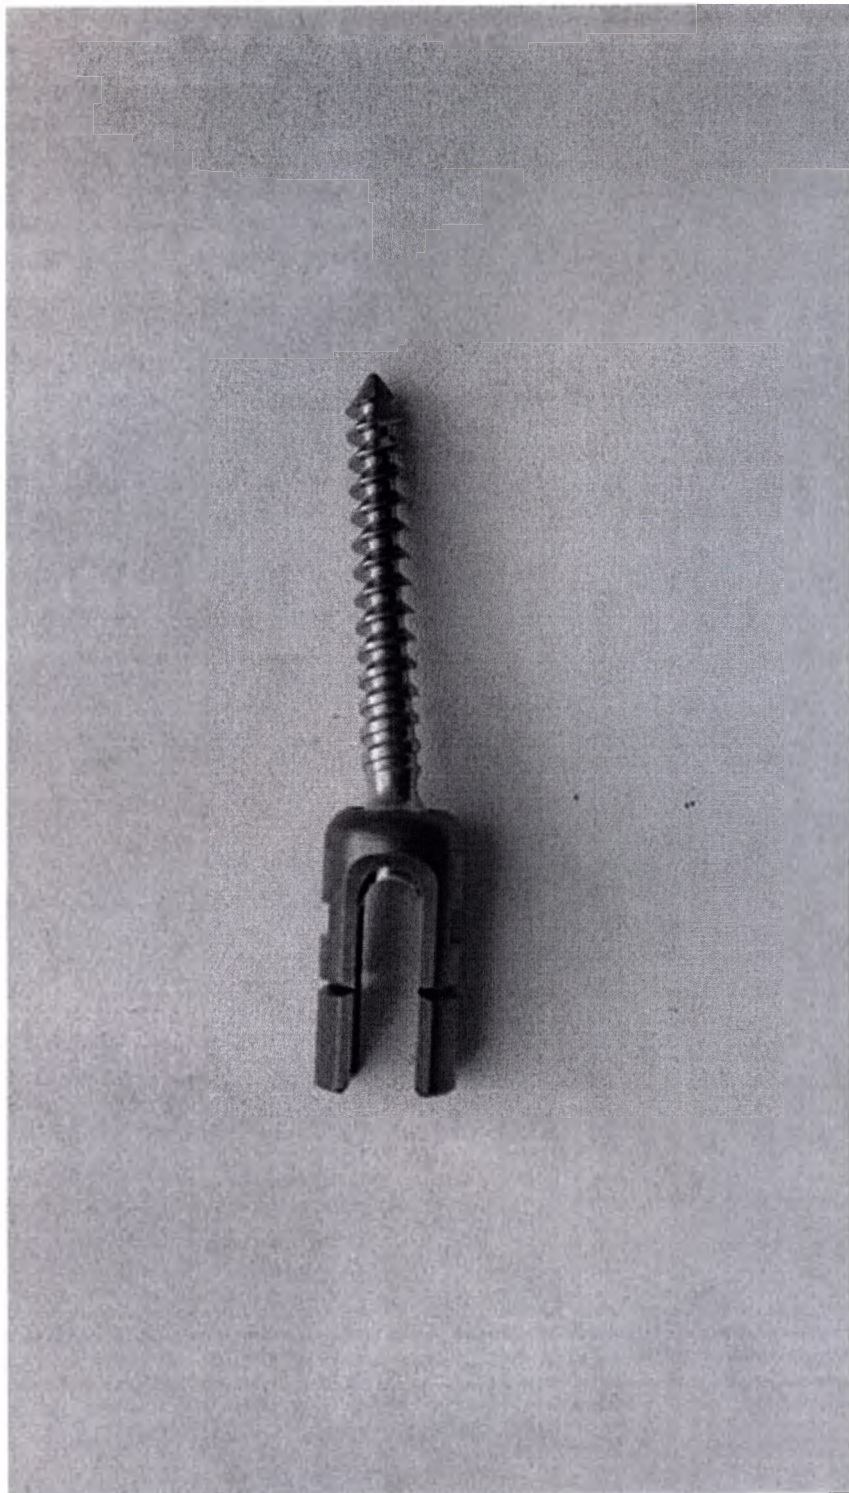

прошито, пронумеровано, 11 л.
скреплено подписью и печатью

(одиннадцать)

Директор ООО «АльфаМедика»

Р.В. Дорожкин
м.п.

