

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

А.В. Емельянов

«15» июля 2024




фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению

Стол массажный терапевтический «Кинезо-Эксперт» по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения

Содержание:

наименование	страницы
фотографические изображения столов массажных вариантов исполнения СМТ	3 - 6
фотографические изображения столов массажных вариантов исполнения для Бобат и Войта терапии	7 - 18
фотографические изображения столов массажных вариантов исполнения с функцией вертикализации	19 - 21
фотографические изображения принадлежностей	22 - 32

Стол массажный 2-х секционный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-2

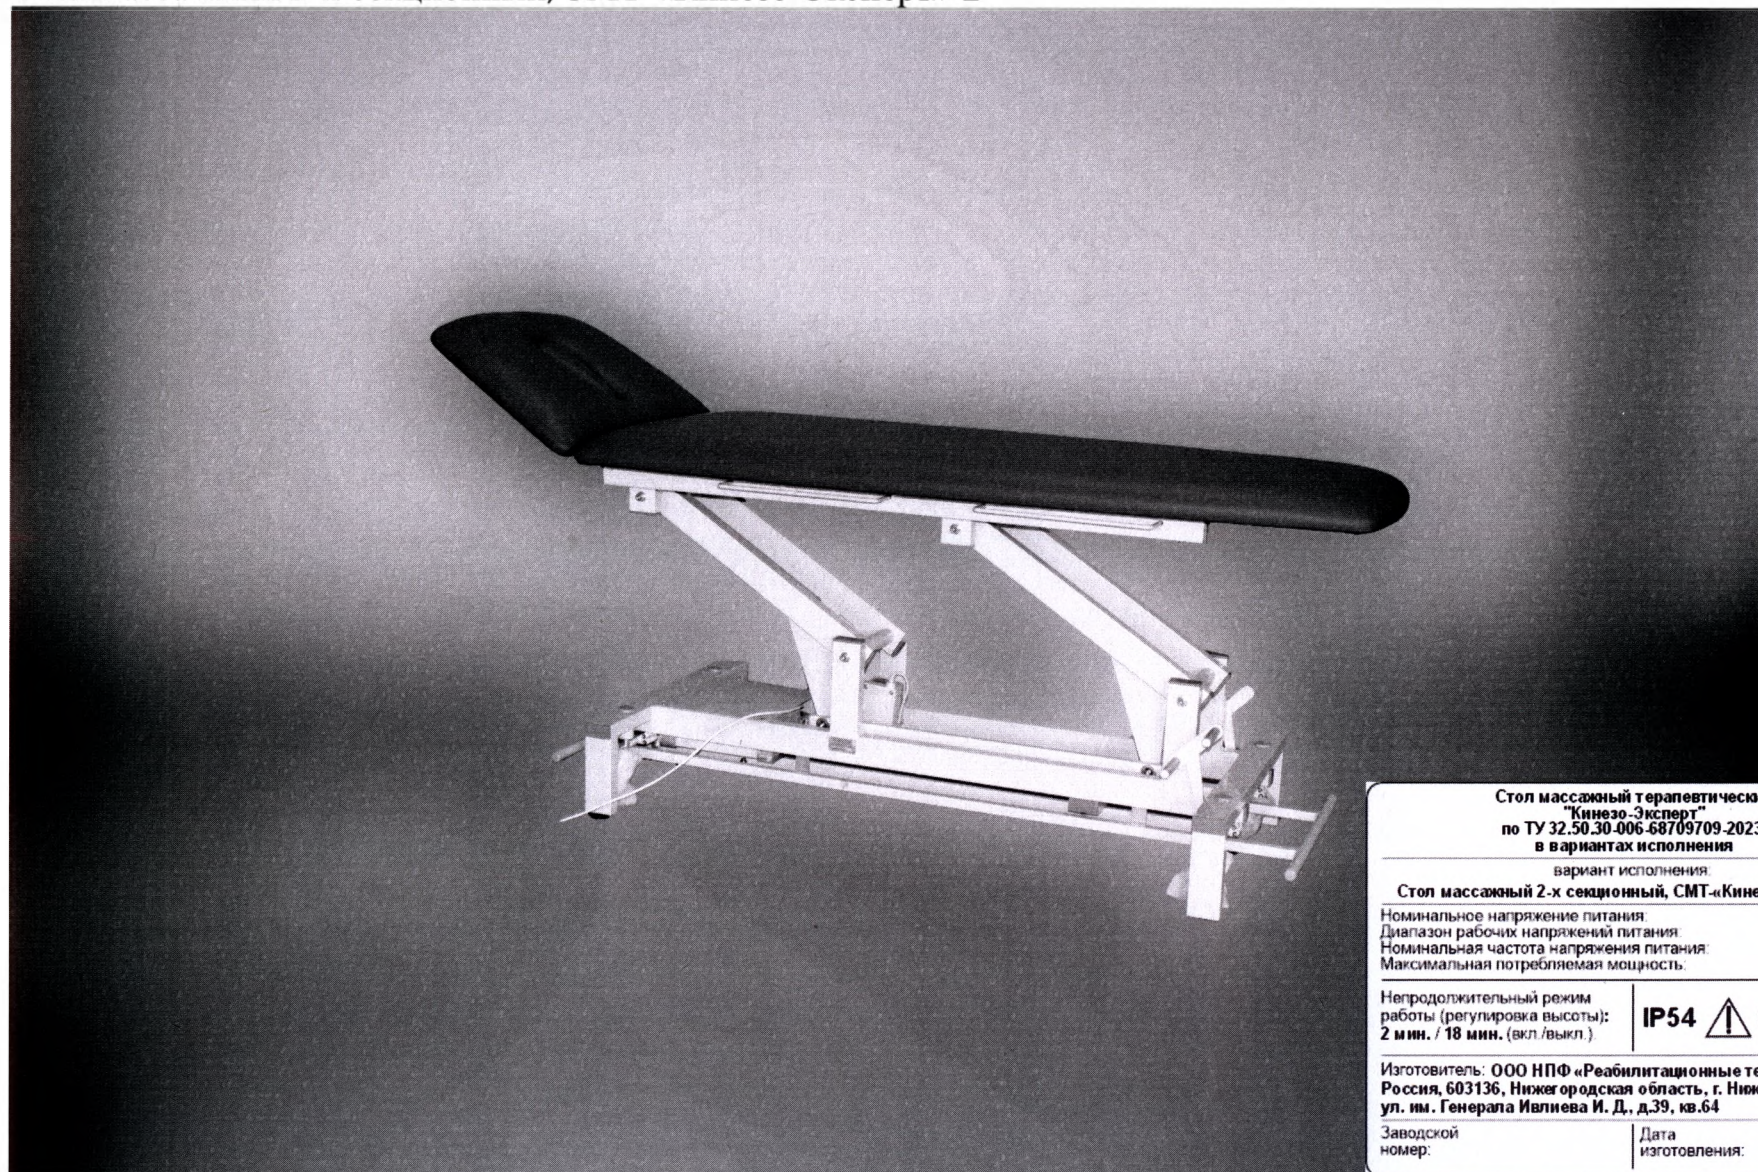

Стол массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт"
по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

вариант исполнения:

Стол массажный 2-х секционный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-2

Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А

Непродолжительный режим
работы (регулировка высоты):
2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)


IP54   

Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»,
Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64

Заводской
номер:


Дата
изготовления:

Стол массажный 3-х секционный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-3

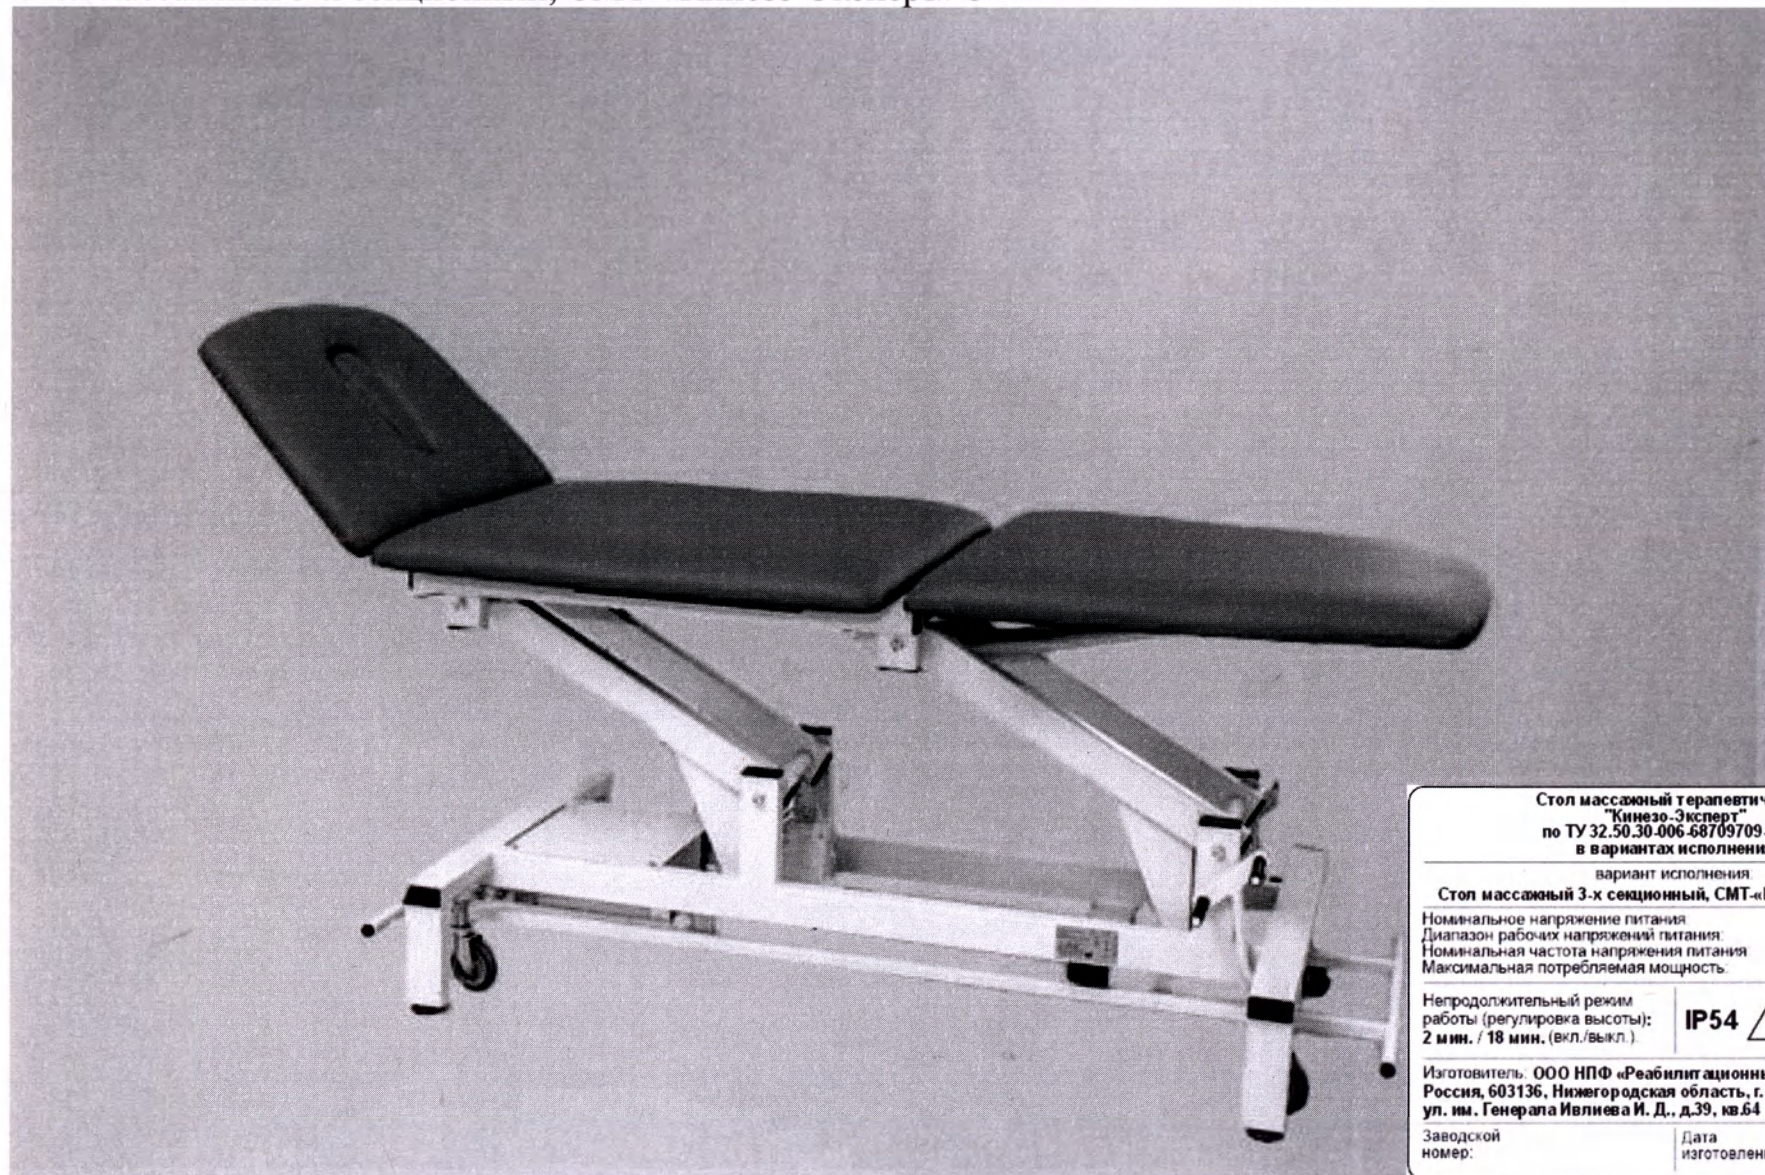


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006.68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 3-х секционный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-3	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	
IP54    	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 7-ми секционный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-7

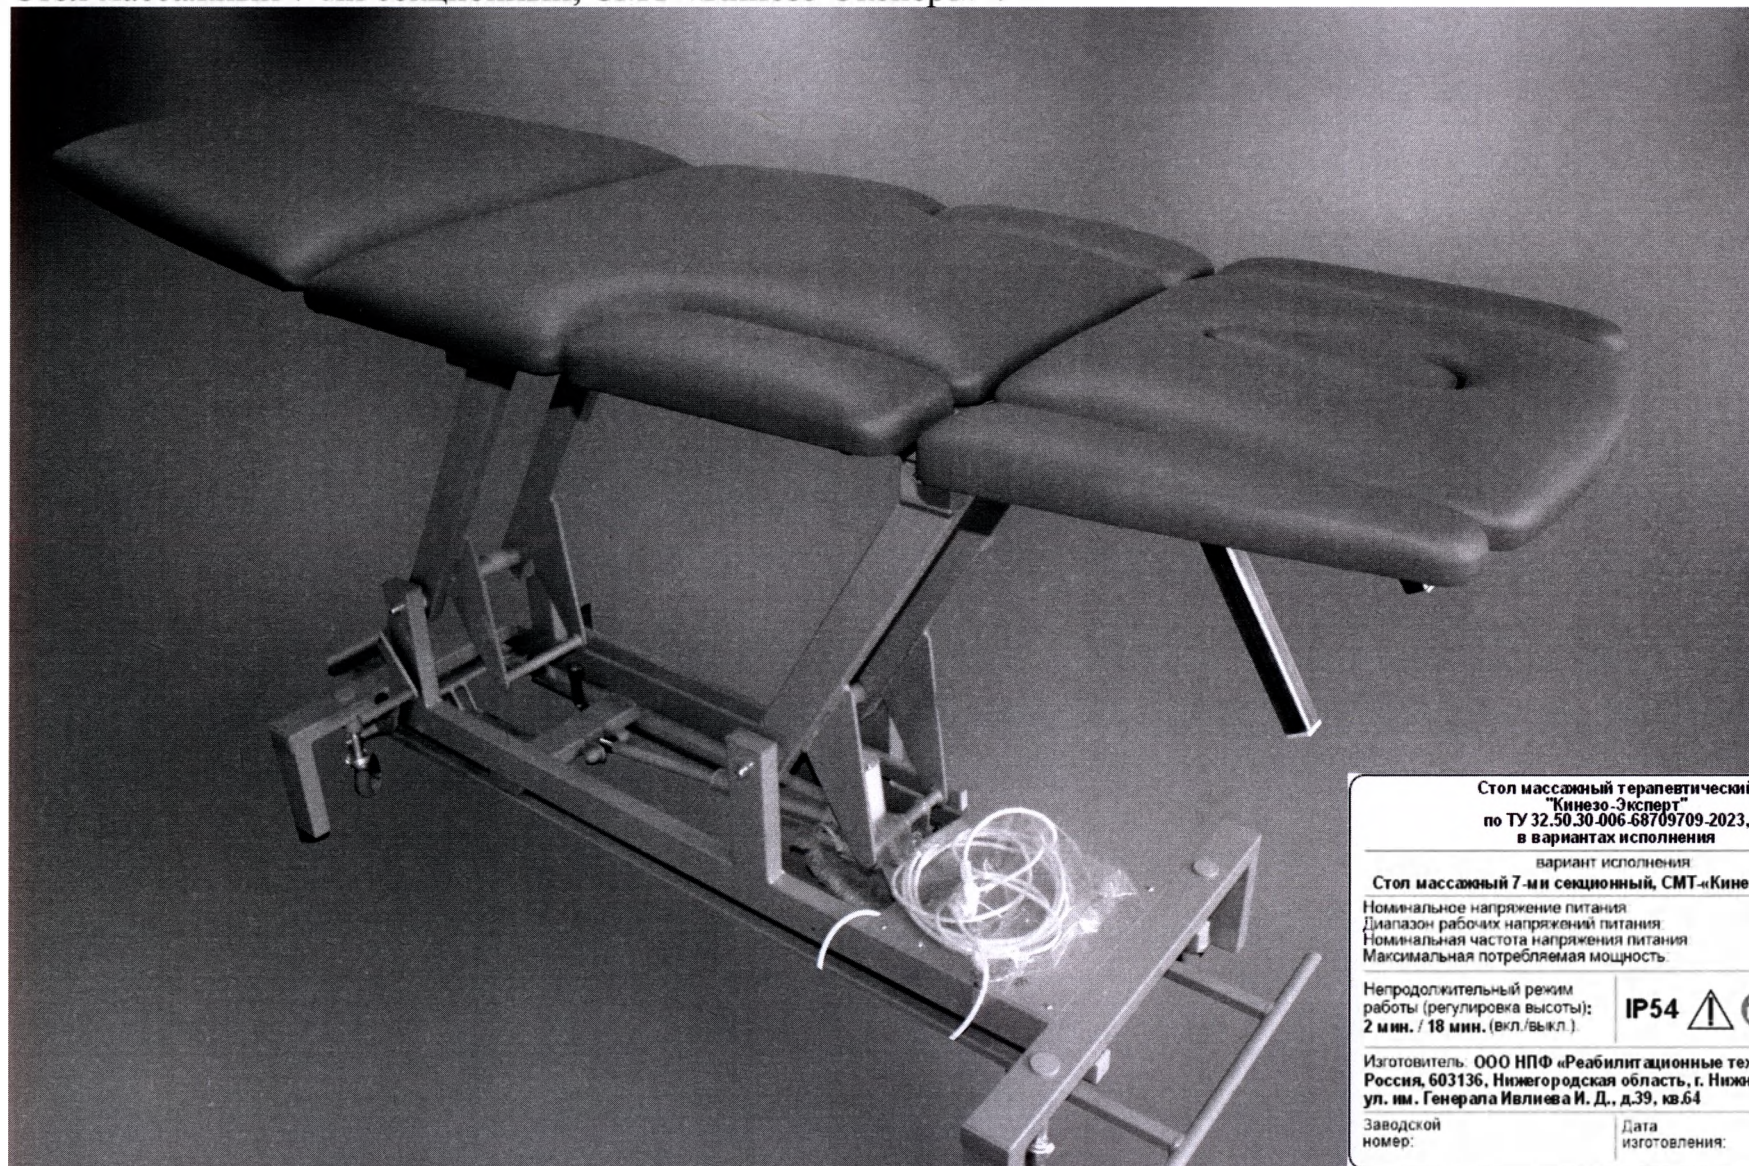


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения	
Стол массажный 7-ми секционный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-7	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 7-ми секционный двухмоторный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-7/2М

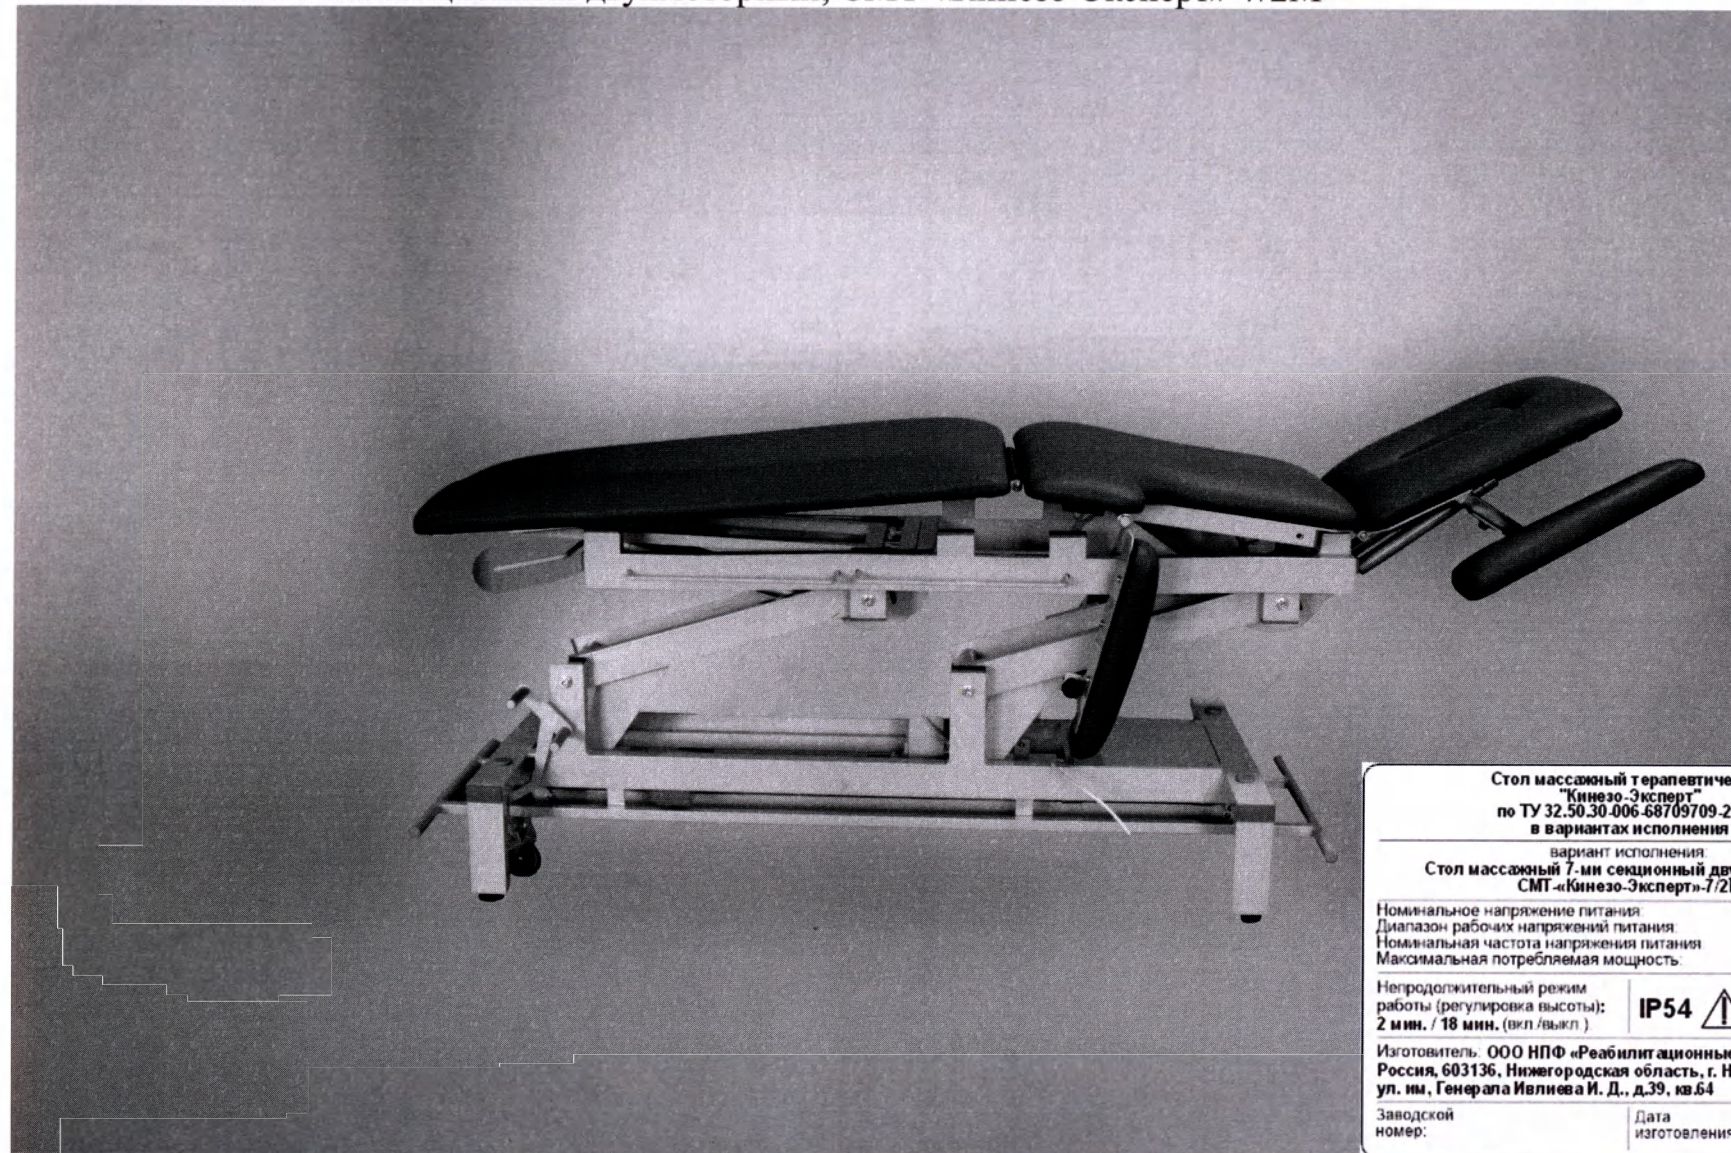


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006.68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 7-ми секционный двухмоторный, СМТ-«Кинезо-Эксперт»-7/2М	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.1

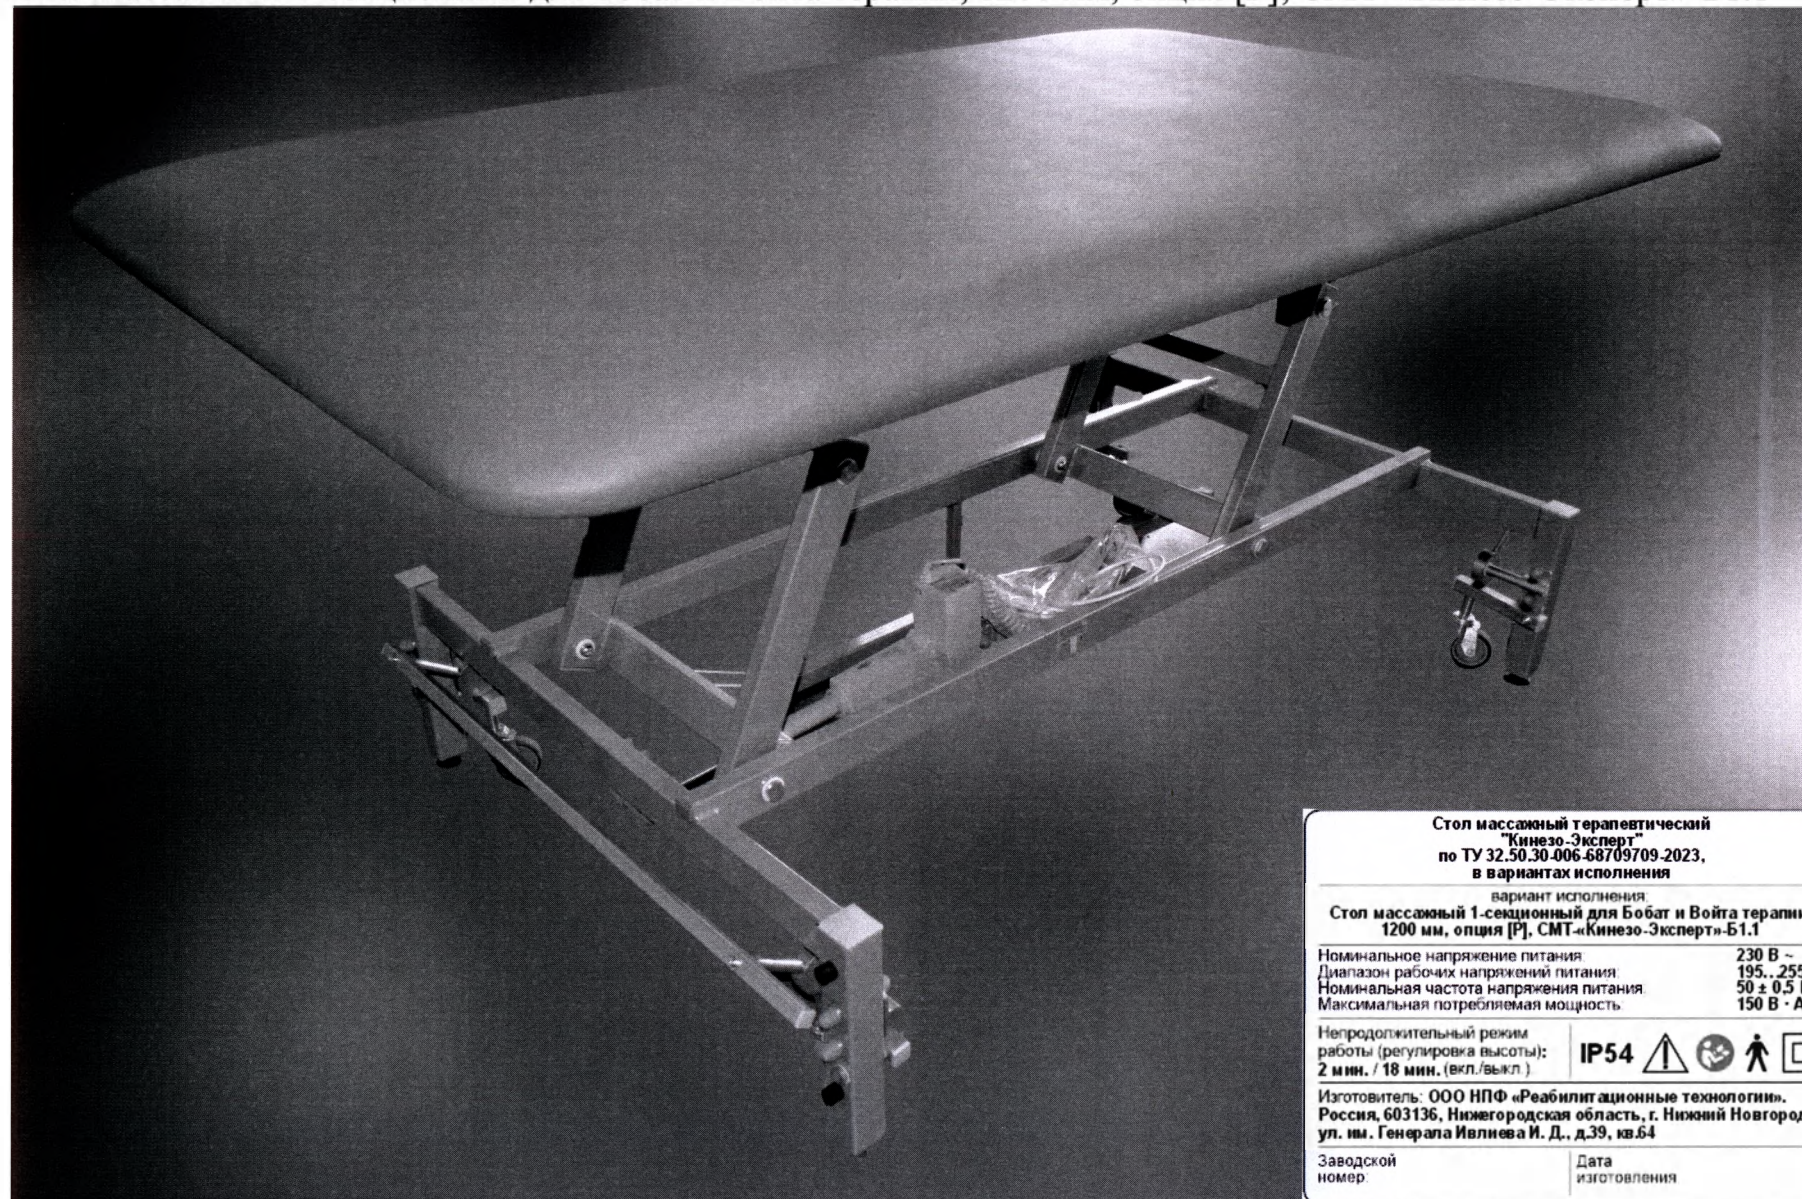

Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения: Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.1	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.2

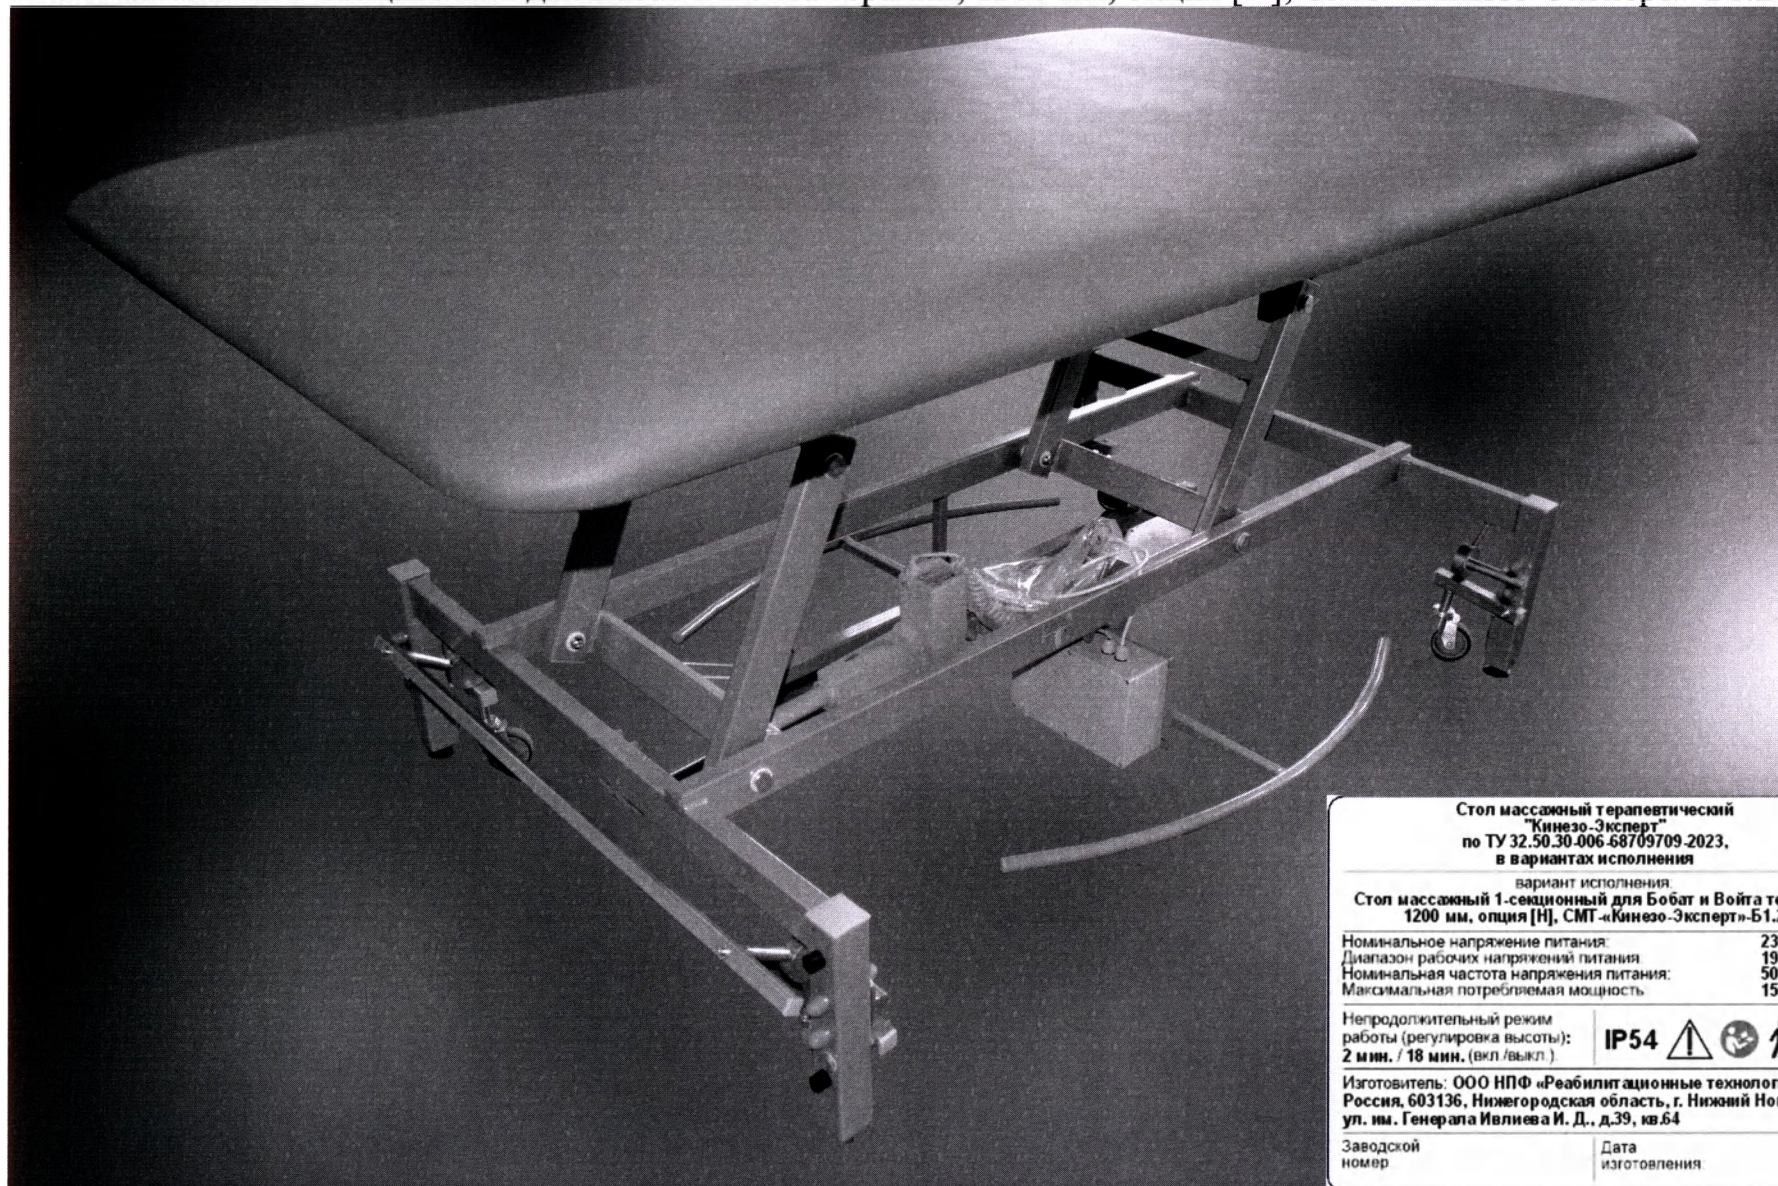


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006.68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.2	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54   
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Р], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.1




Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Р], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.1	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54 ⚠ ♻ ♿ □
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.2

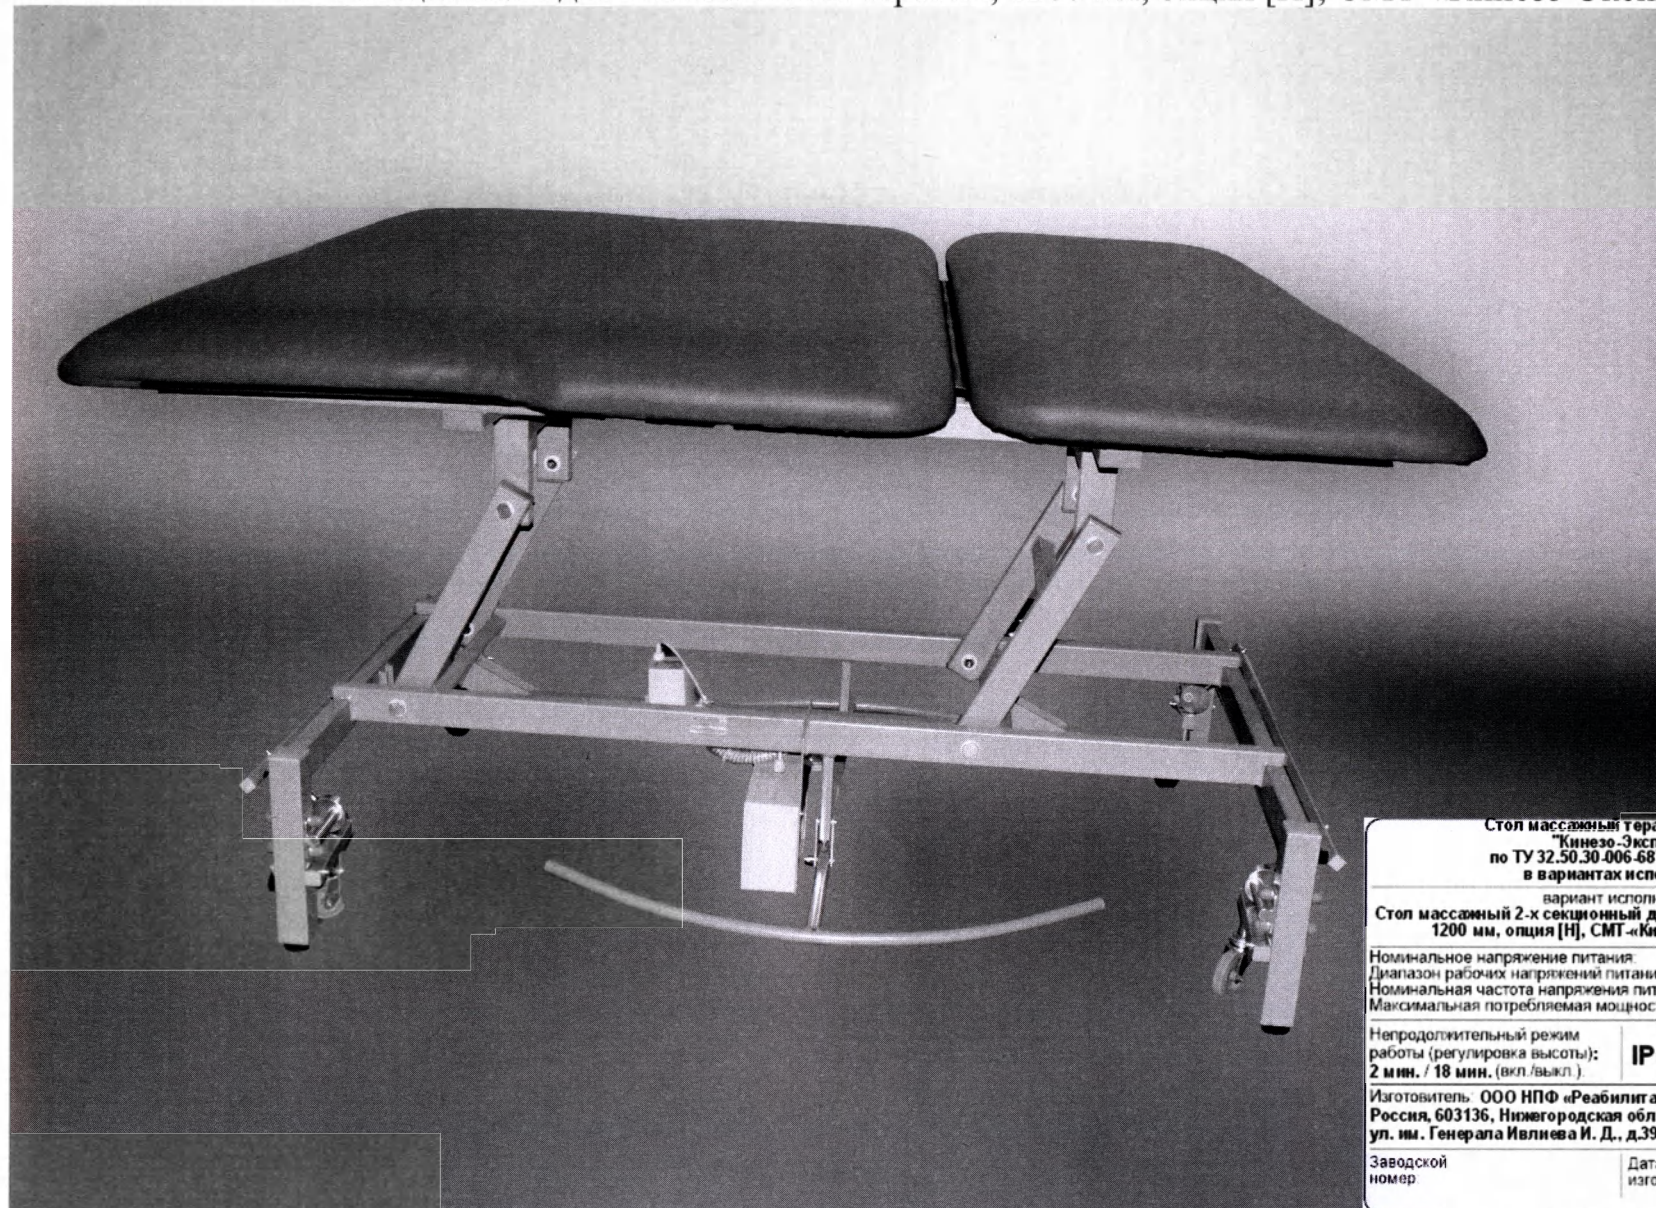


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.2	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.1

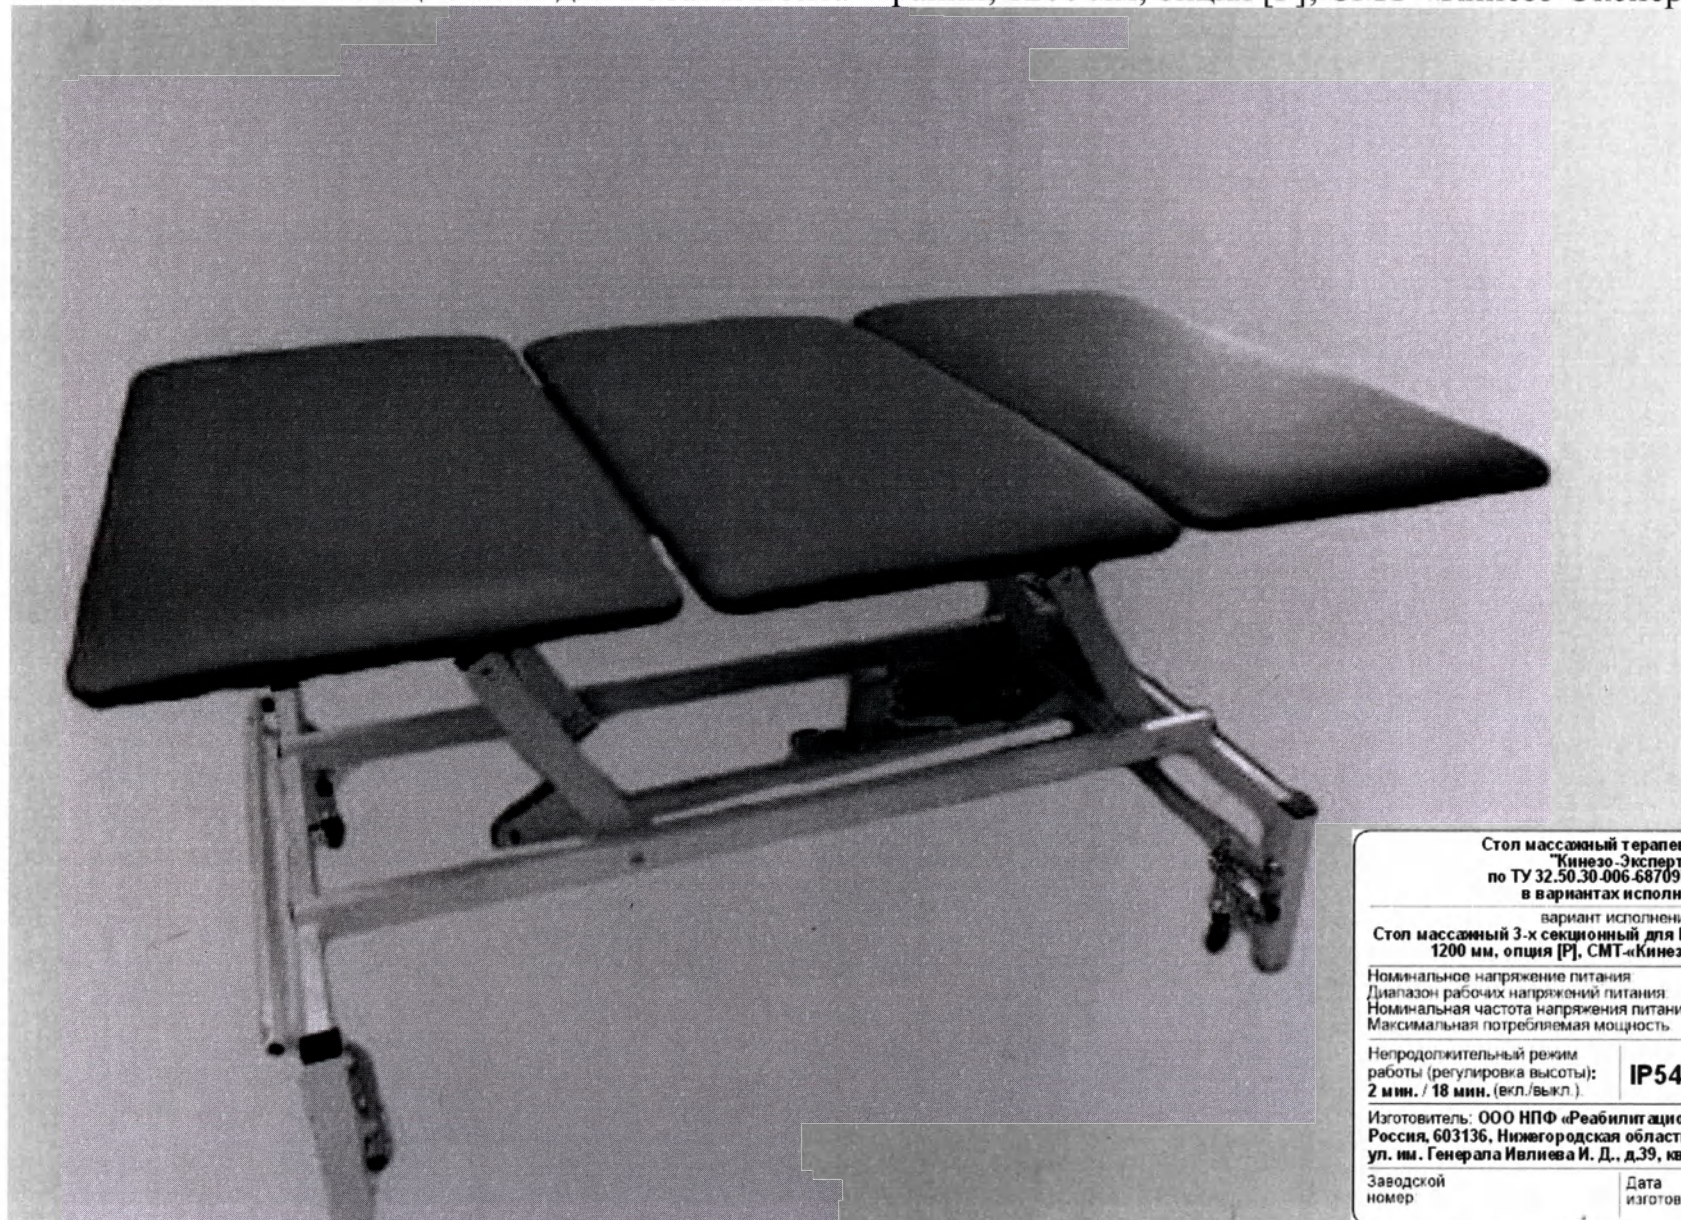


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения: Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.1	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195..255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.2

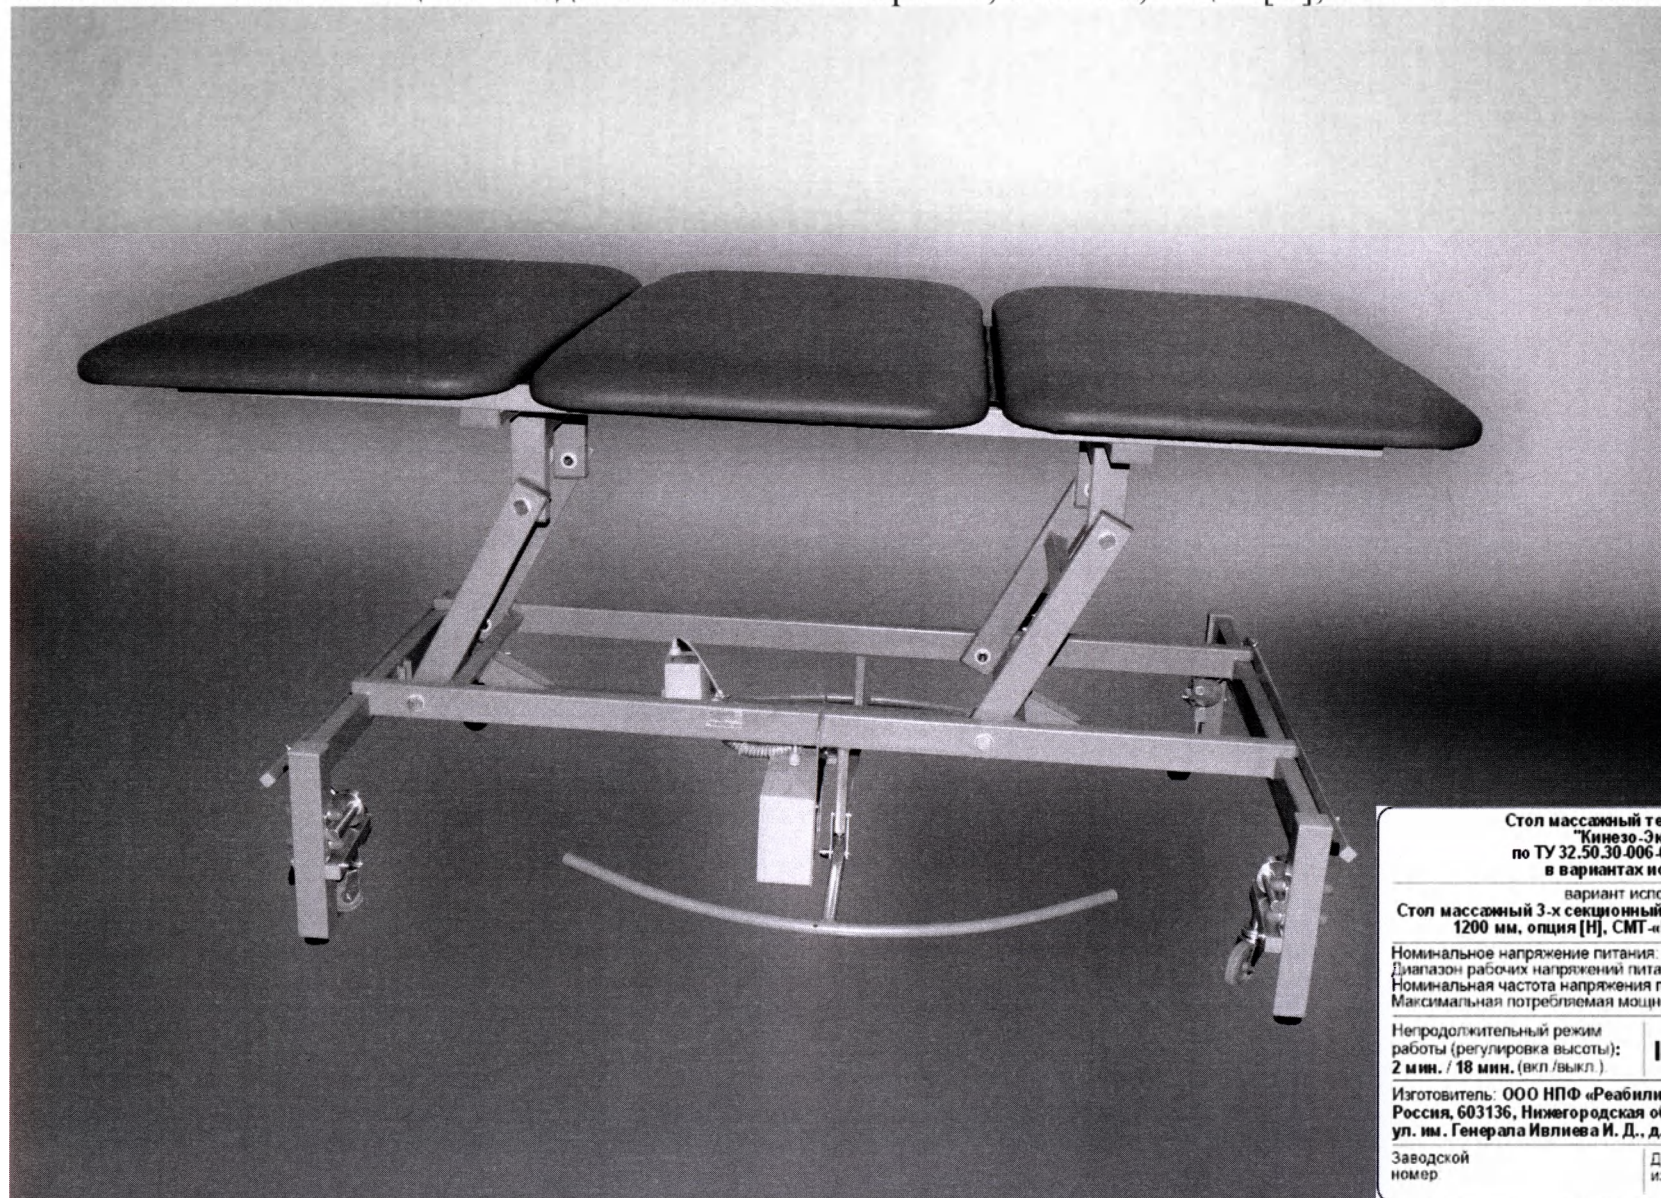


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006.68709709.2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1200 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.2	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.3

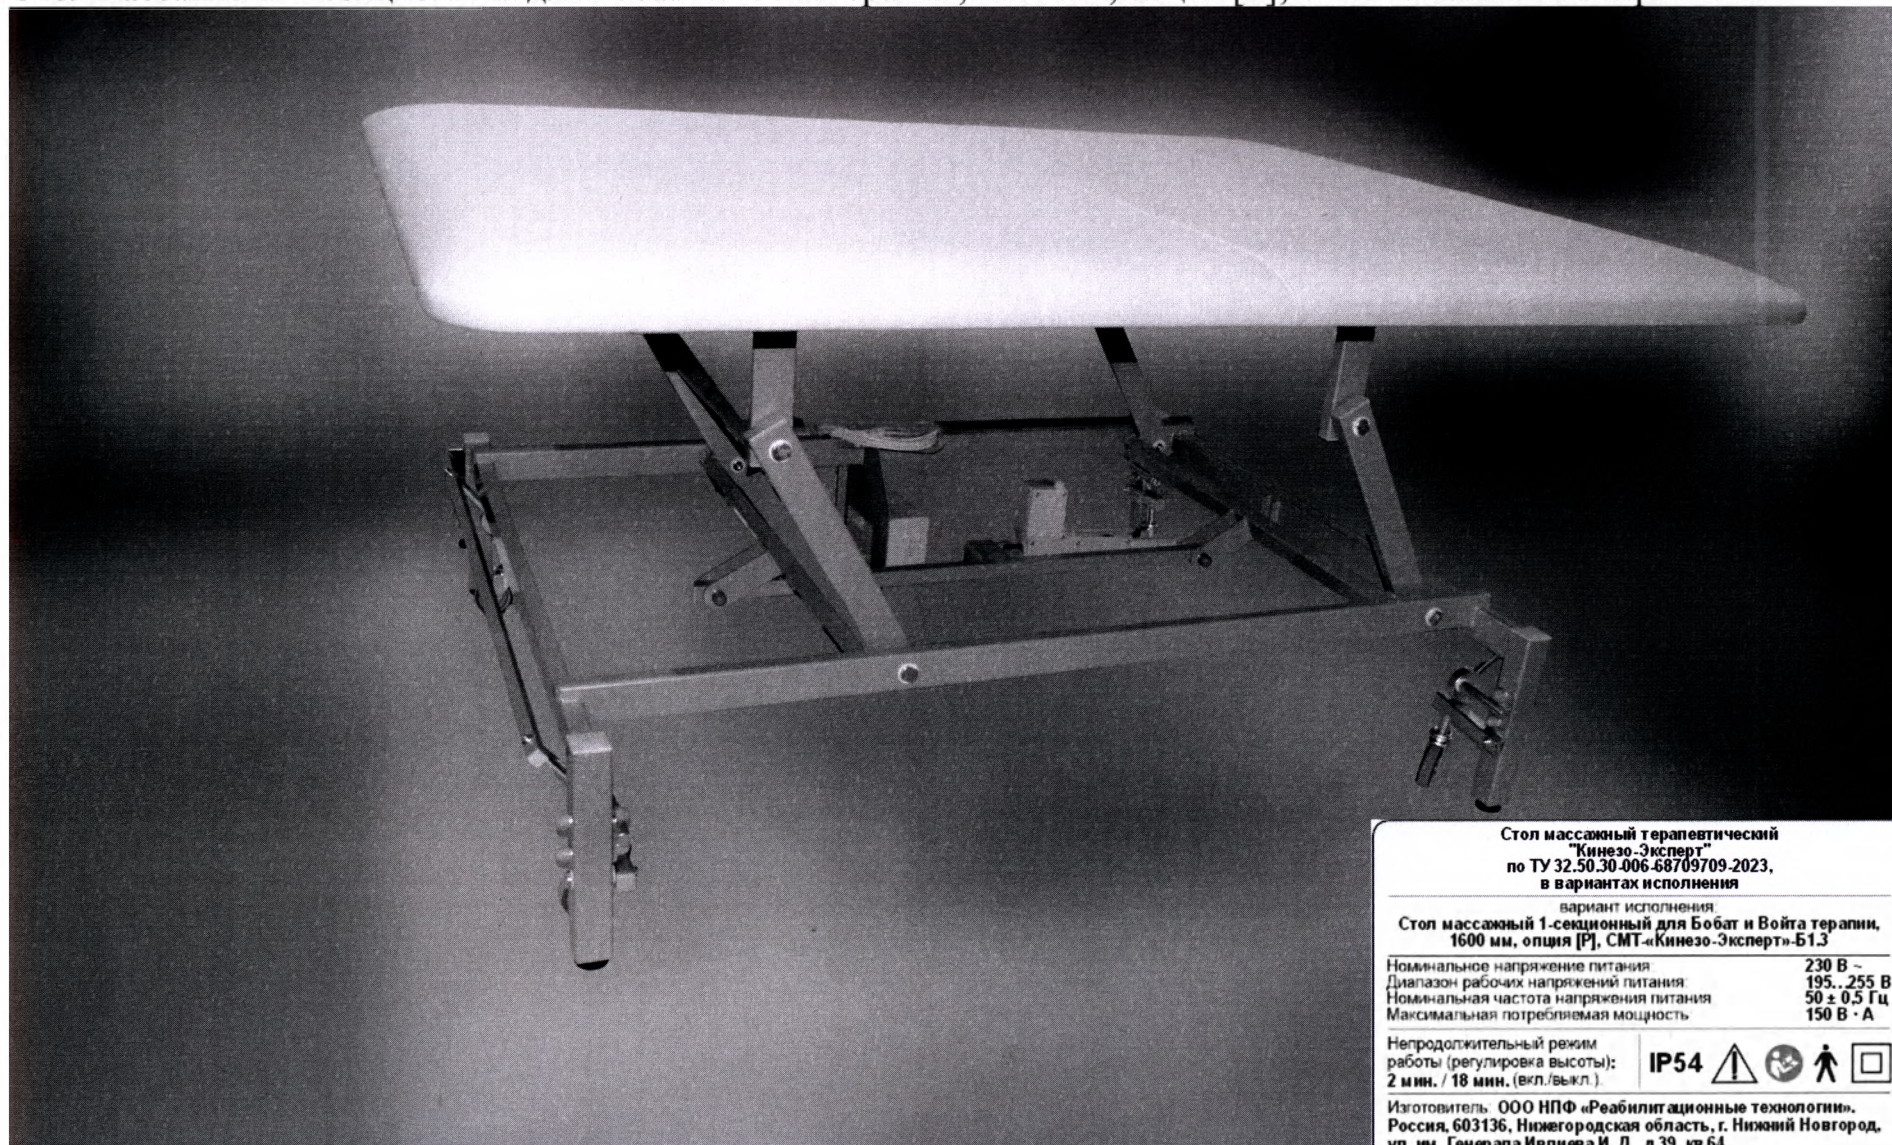


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.3	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54   
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.4

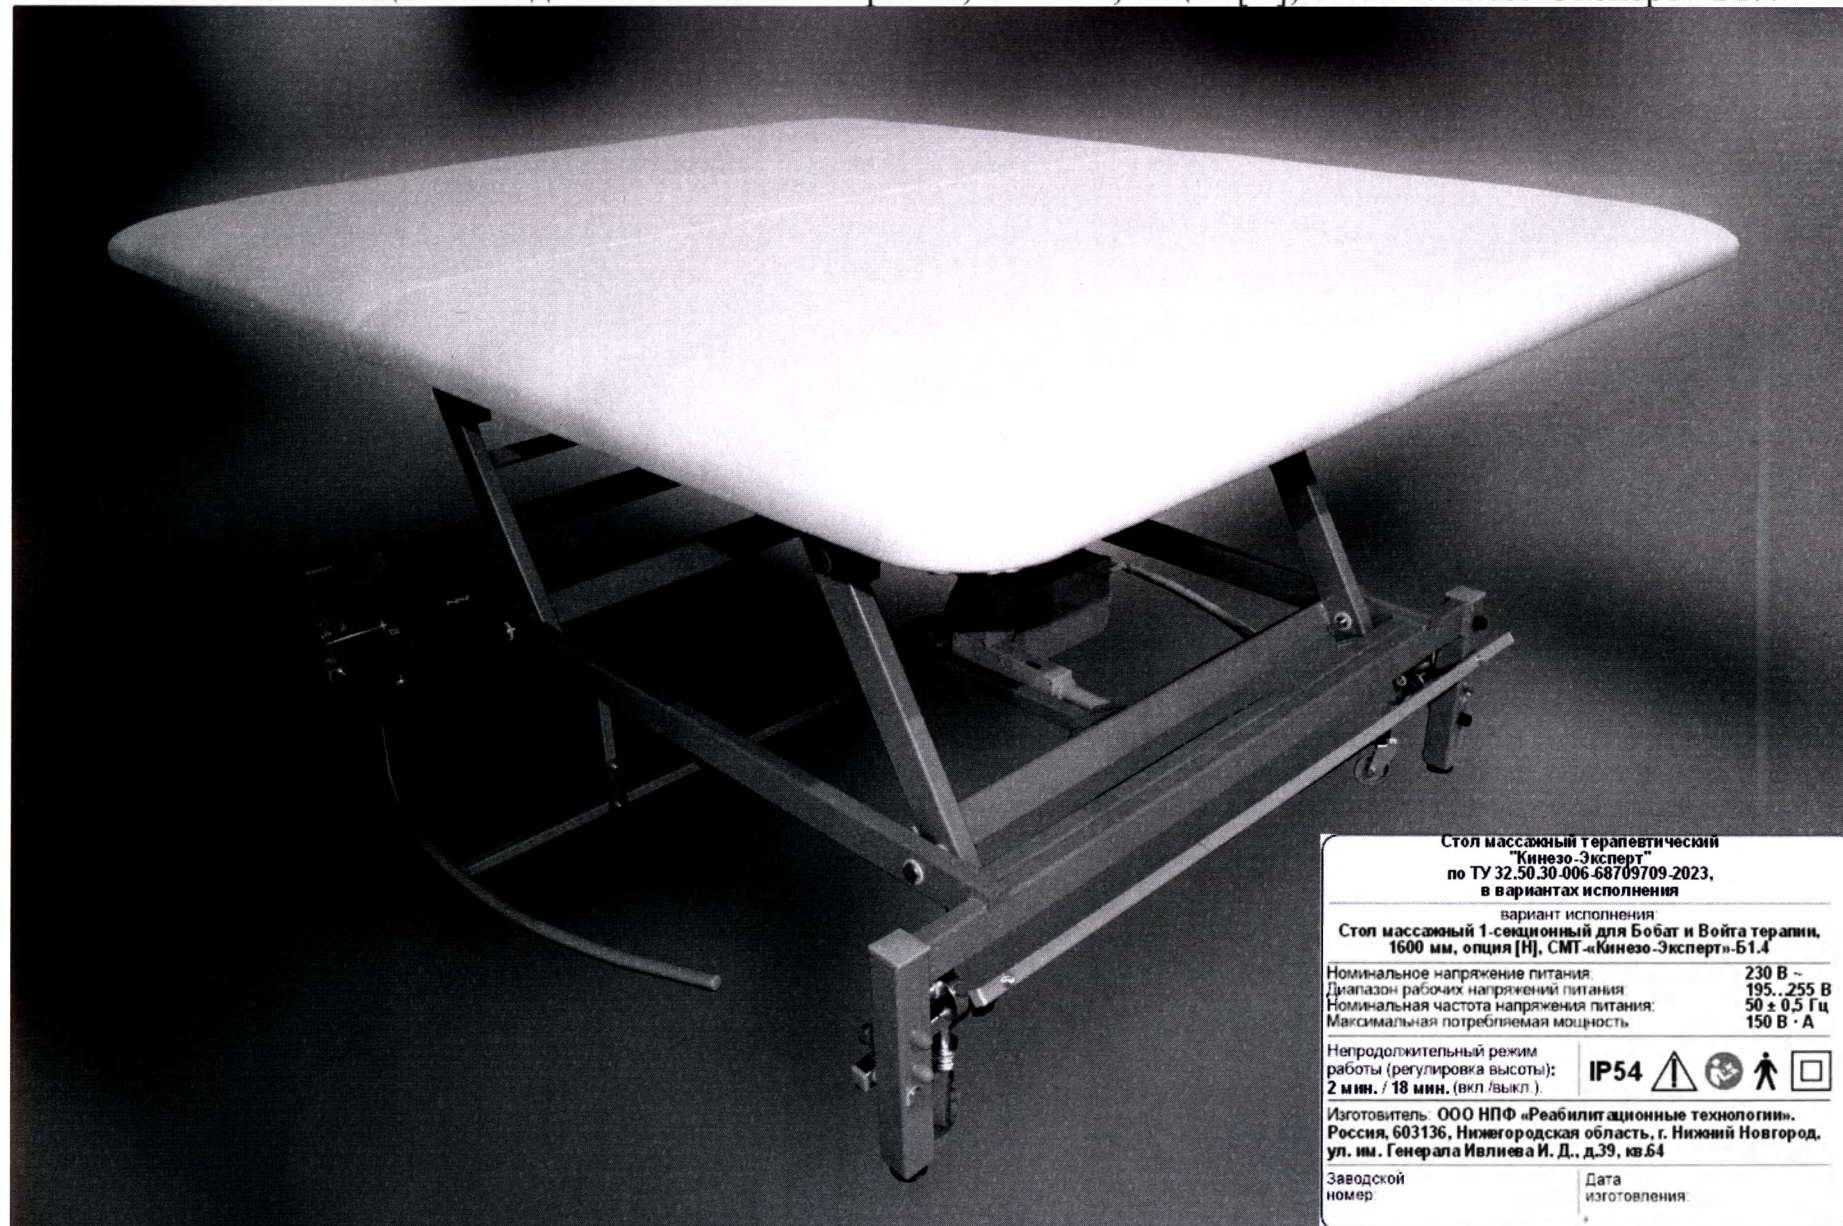


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения: Стол массажный 1-секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б1.4	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.3

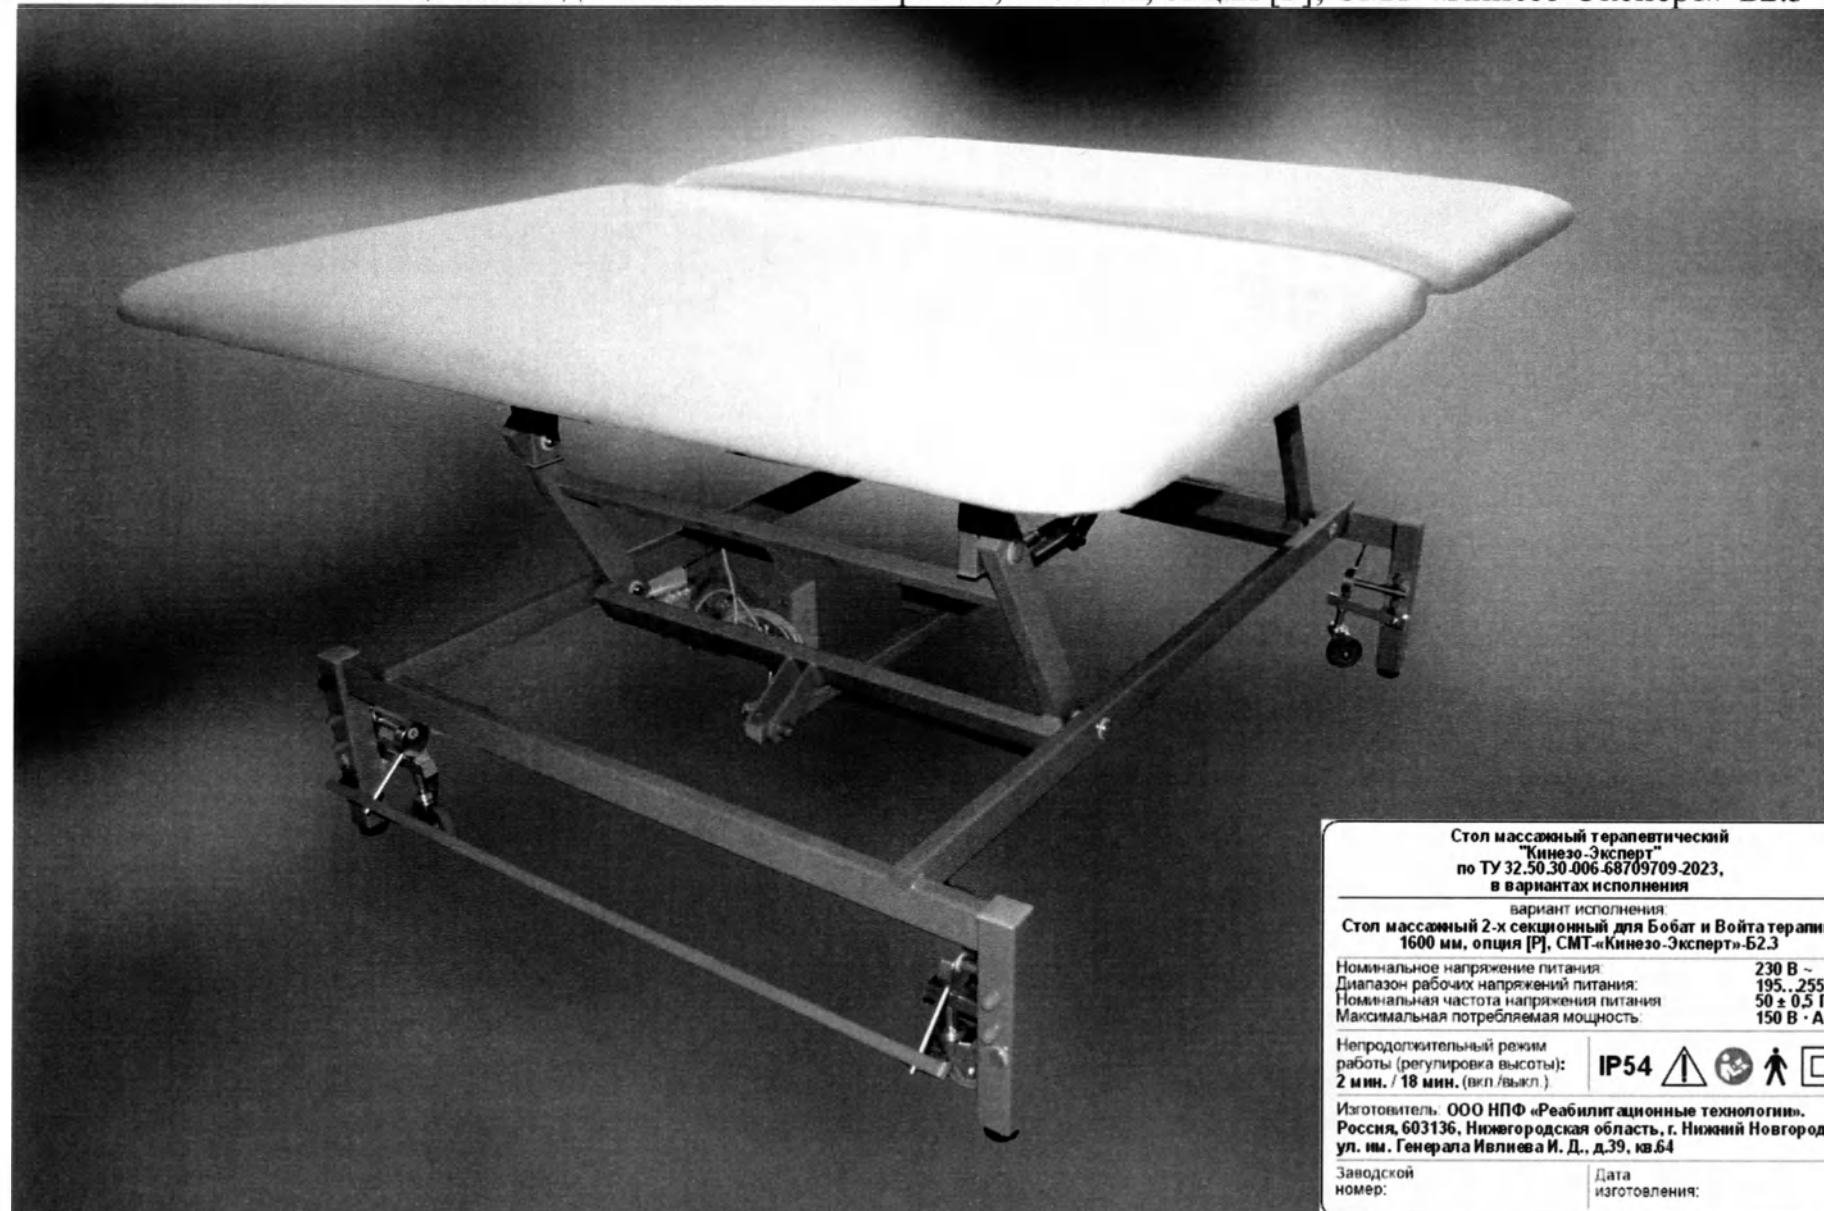

Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения: Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.3	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.4

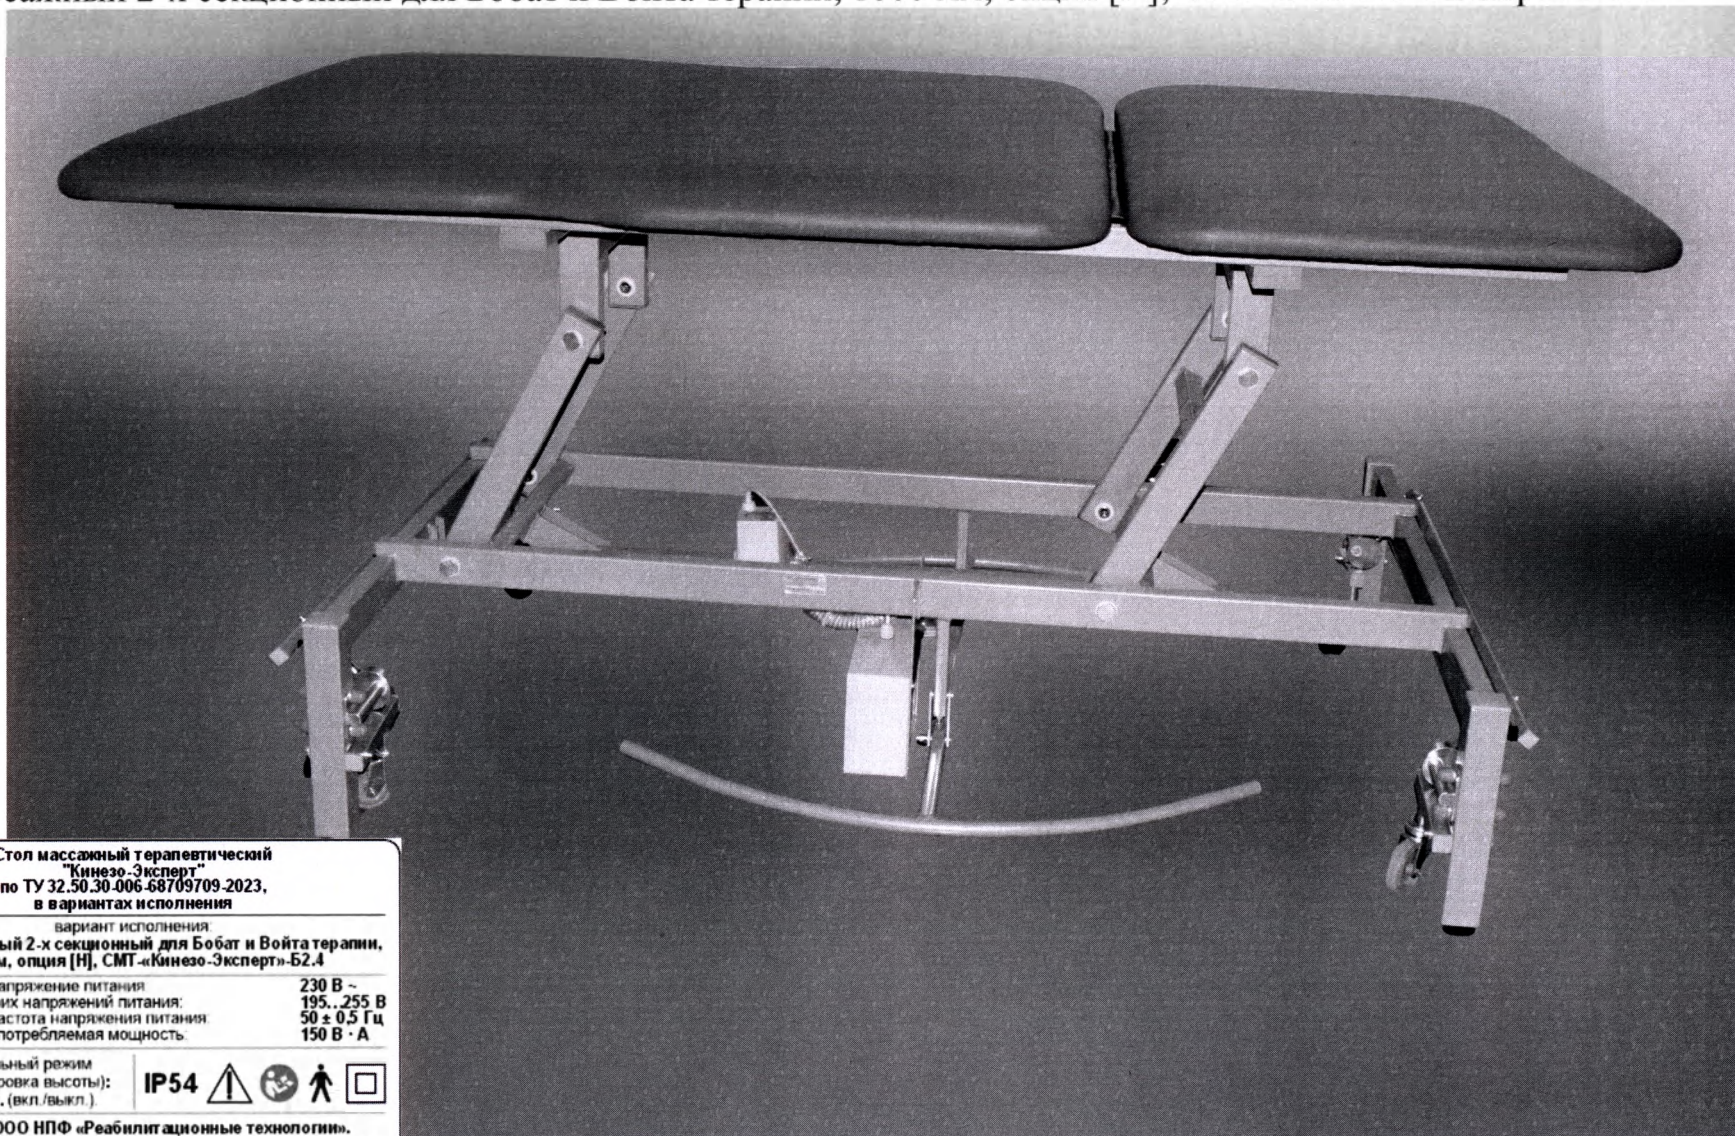

Стол массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт"
по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

вариант исполнения

Стол массажный 2-х секционный для Бобат и Войта терапии,
1600 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б2.4

Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195..255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А

Непродолжительный режим
работы (регулировка высоты):
2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)




Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64

Заводской
номер


Дата
изготовления

Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.3

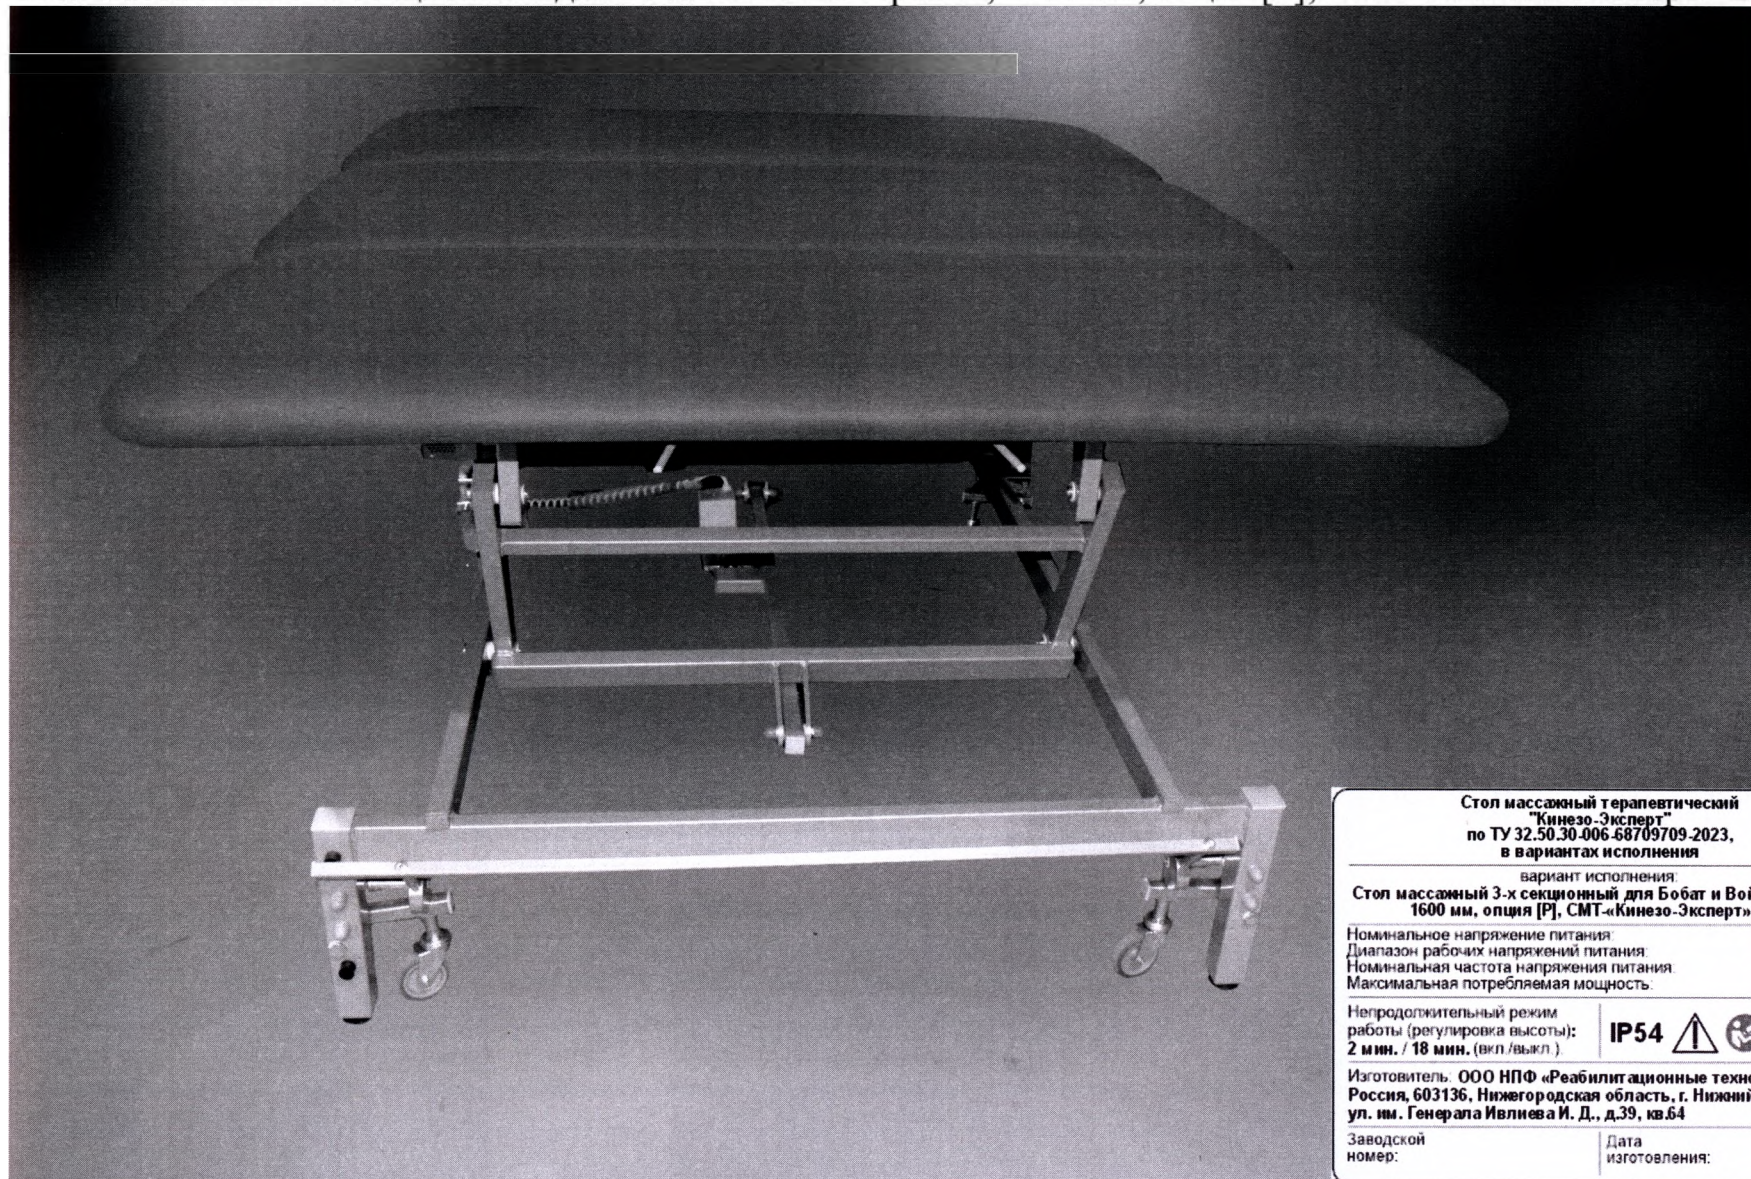


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения: Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [P], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.3	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0.5 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54 ⚠ ♻ ♿ □
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.4

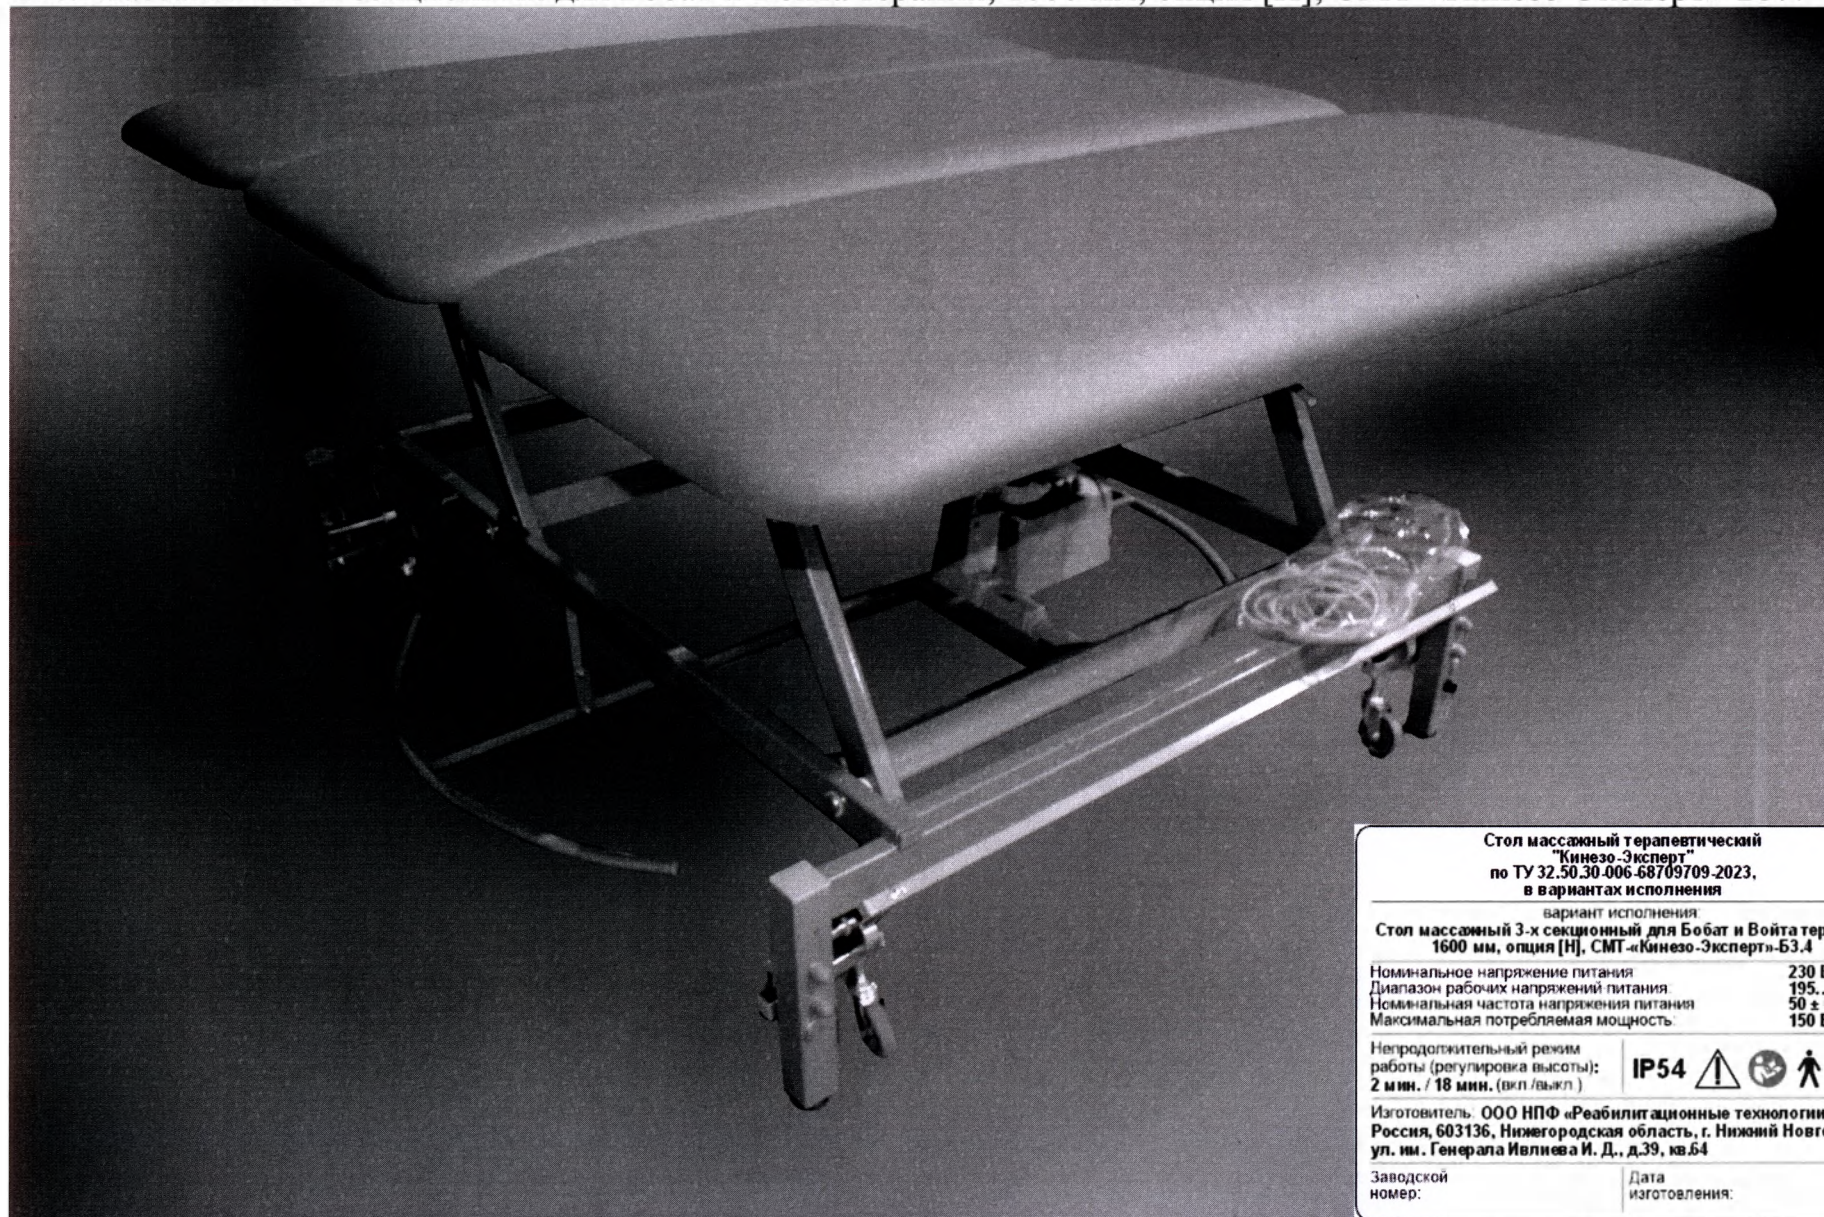


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 3-х секционный для Бобат и Войта терапии, 1600 мм, опция [Н], СМТ-«Кинезо-Эксперт»-Б3.4	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	150 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления:

Стол массажный 1-секционный с функцией вертикализации одномоторный, СМТВ-«Кинезо-Эксперт»-1

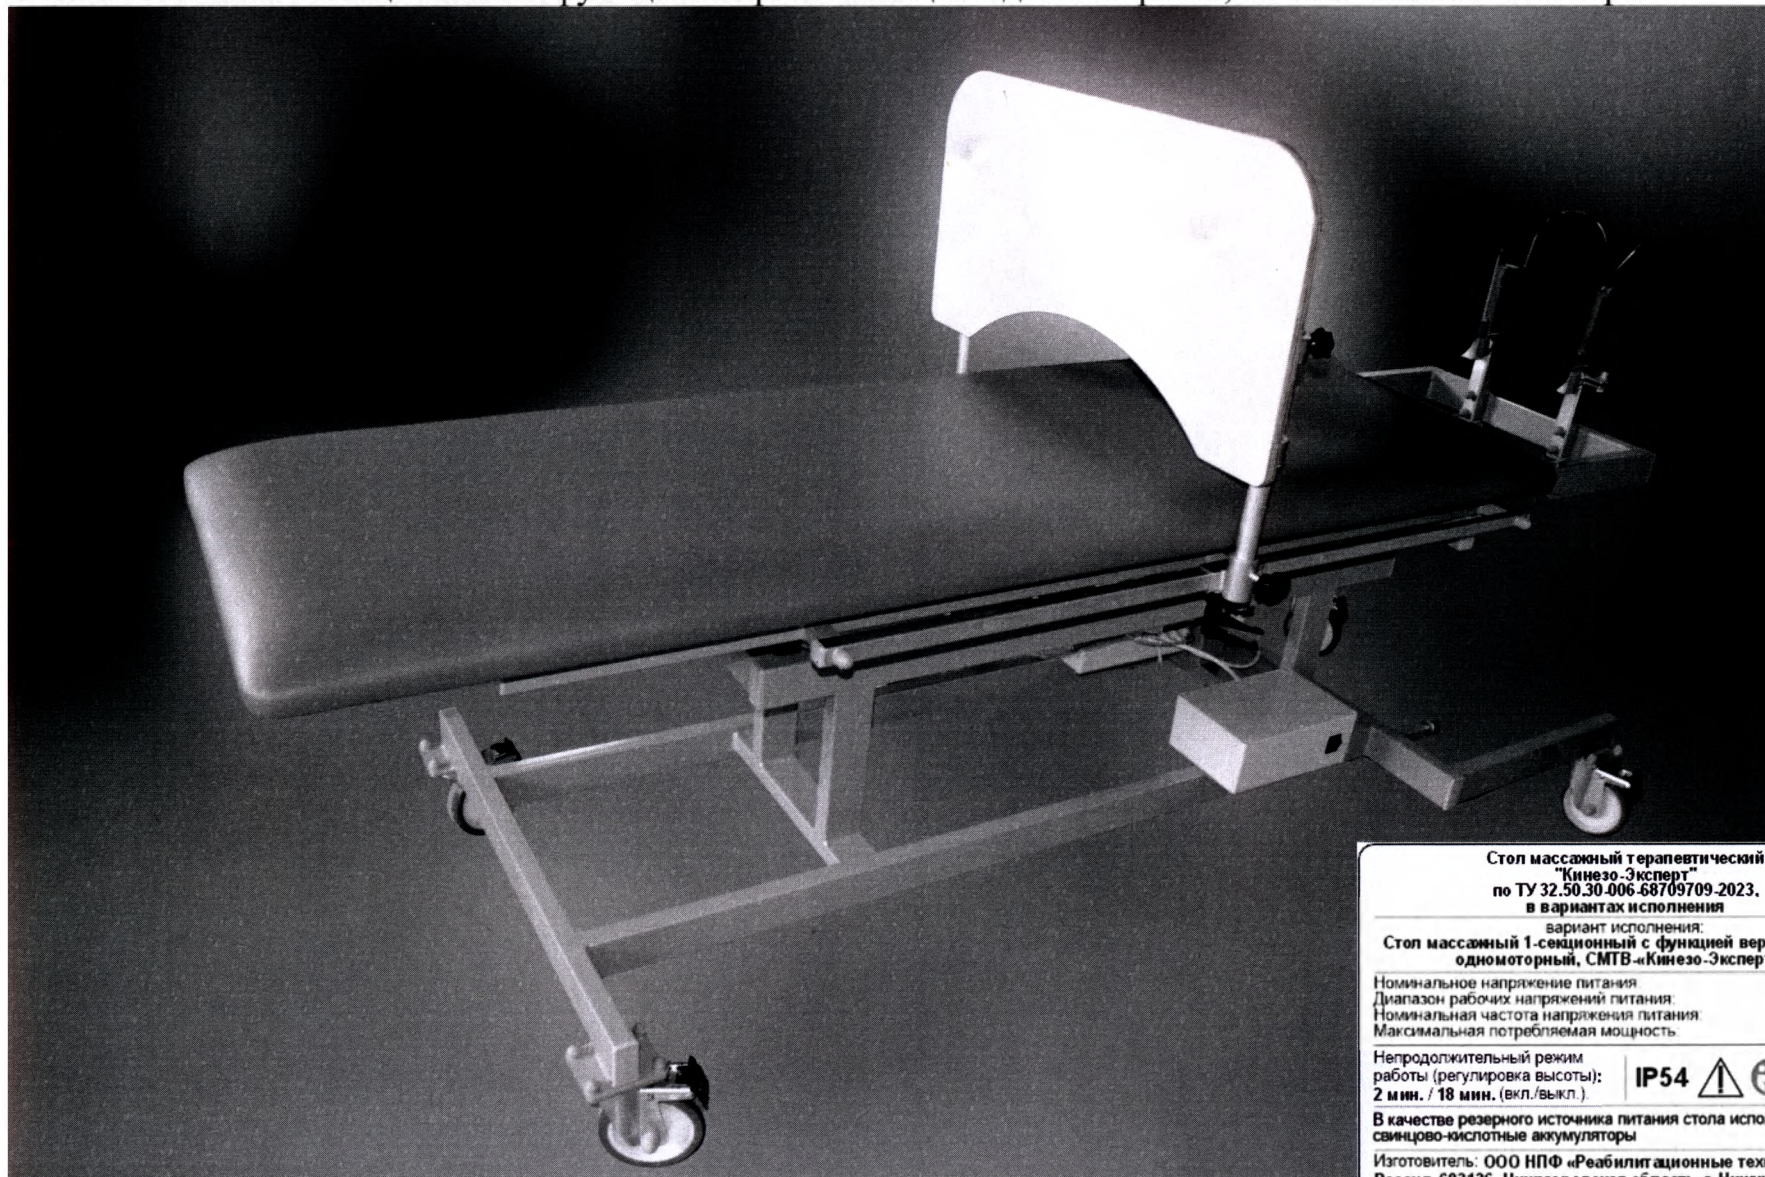


Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006.68709709-2023. в вариантах исполнения	
вариант исполнения: Стол массажный 1-секционный с функцией вертикализации одномоторный, СМТВ-«Кинезо-Эксперт»-1	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	200 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54
В качестве резервного источника питания стола используются свинцово-кислотные аккумуляторы	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер	Дата изготовления

Стол массажный 1-секционный с функцией вертикализации двухмоторный, СМТВ-«Кинезо-Эксперт»-1/2М

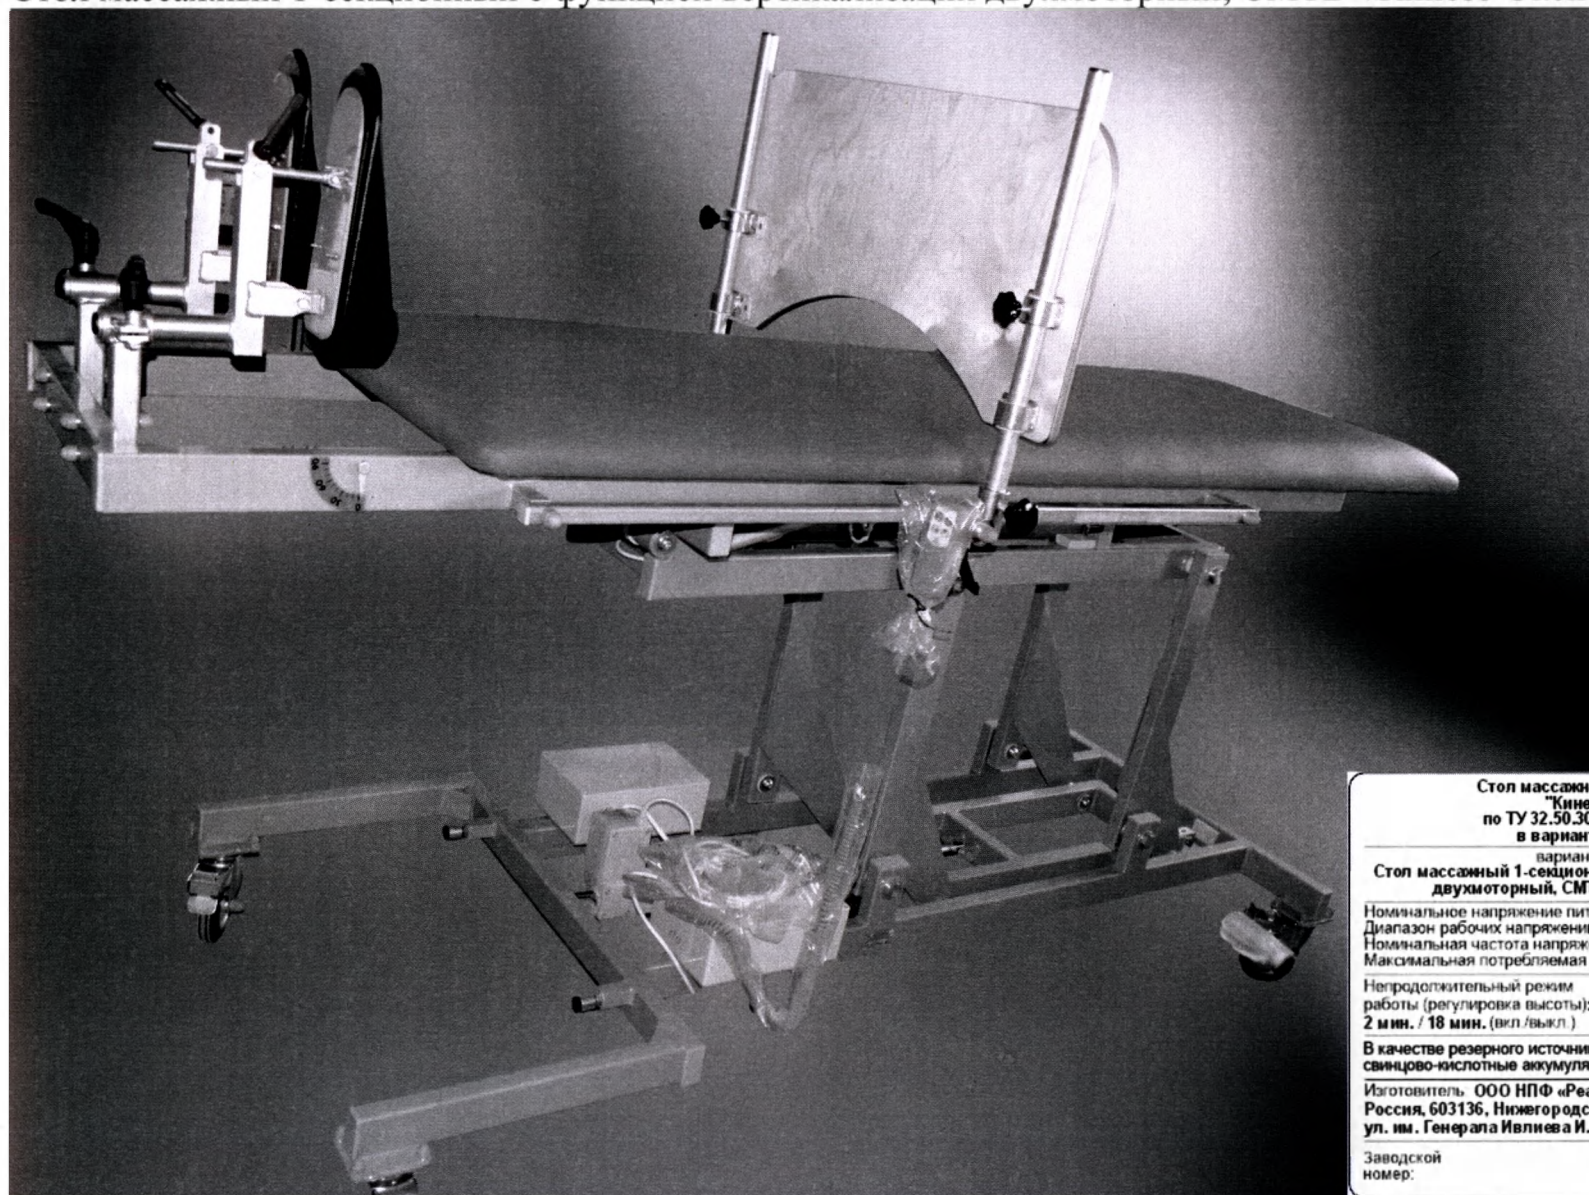

Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 1-секционный с функцией вертикализации двухмоторный, СМТВ-«Кинезо-Эксперт»-1/2М	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания:	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	200 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
В качестве резервного источника питания стола используются свинцово-кислотные аккумуляторы	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления


Стол массажный 2-х секционный с функцией вертикализации двухмоторный, СМТВ-«Кинезо-Эксперт»-2/2М

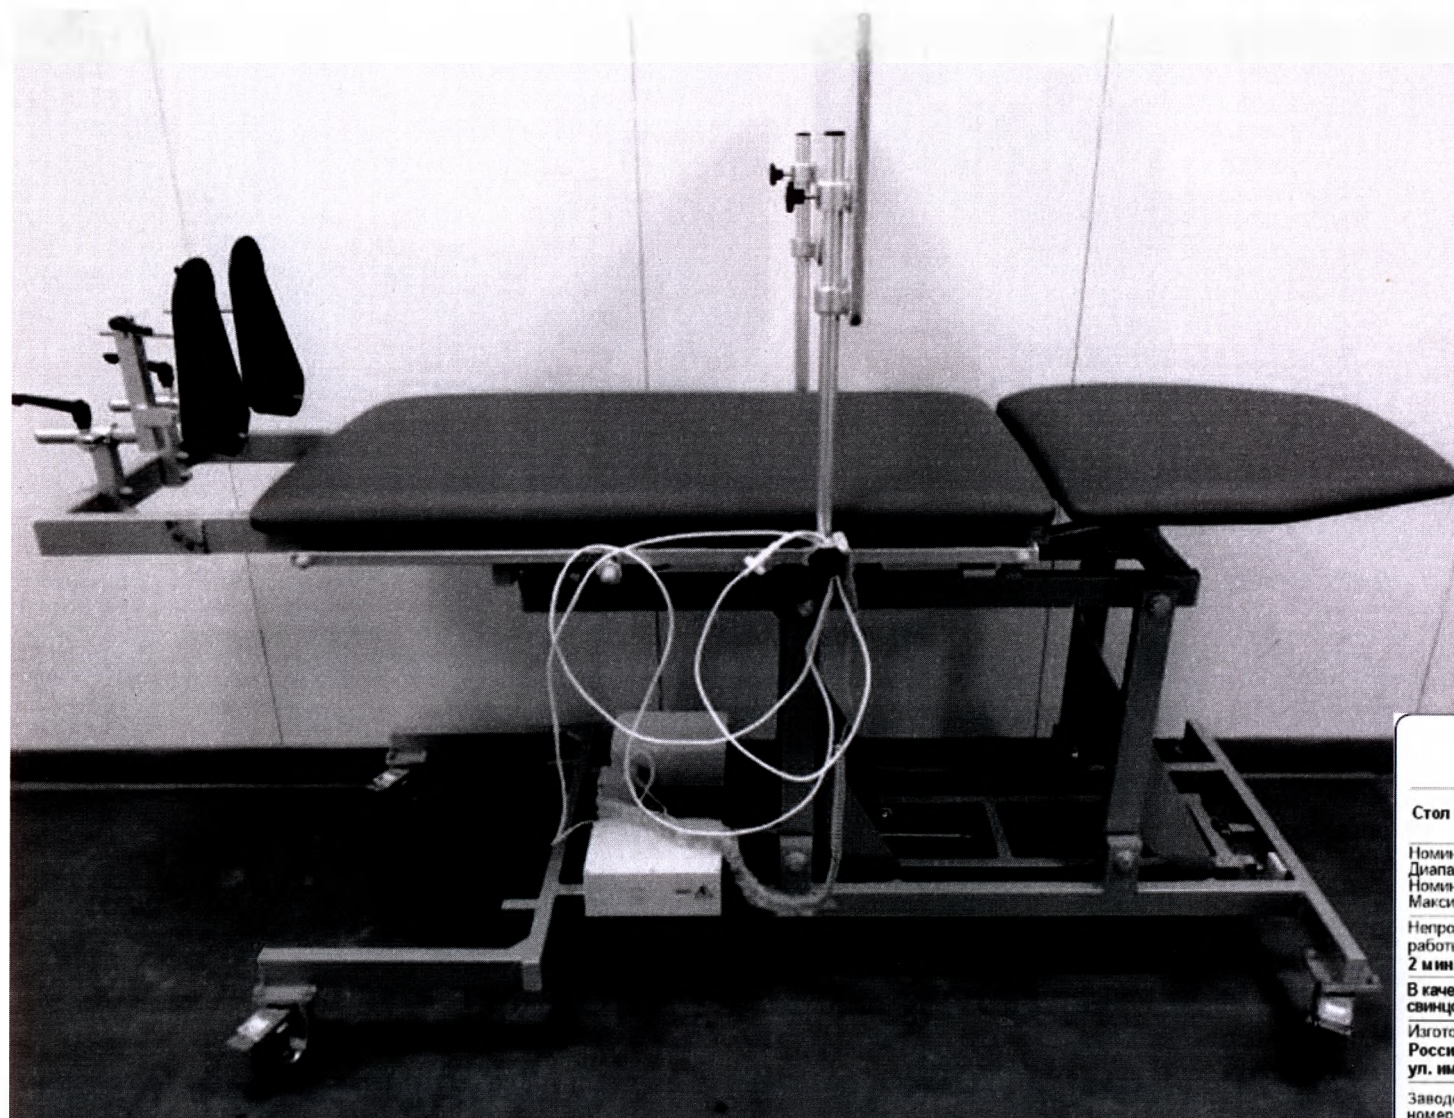

Стол массажный терапевтический "Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30.006.68709709-2023, в вариантах исполнения	
вариант исполнения Стол массажный 2-х секционный с функцией вертикализации двухмоторный, СМТВ-«Кинезо-Эксперт»-2/2М	
Номинальное напряжение питания	230 В ~
Диапазон рабочих напряжений питания	195...255 В
Номинальная частота напряжения питания	50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность	200 В · А
Непродолжительный режим работы (регулировка высоты): 2 мин. / 18 мин. (вкл./выкл.)	IP54    
В качестве резервного источника питания стола используются свинцово-кислотные аккумуляторы	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Заводской номер:	Дата изготовления

Принадлежности:

Клин для реабилитационных упражнений 25 x 60 x 70 см (при необходимости)

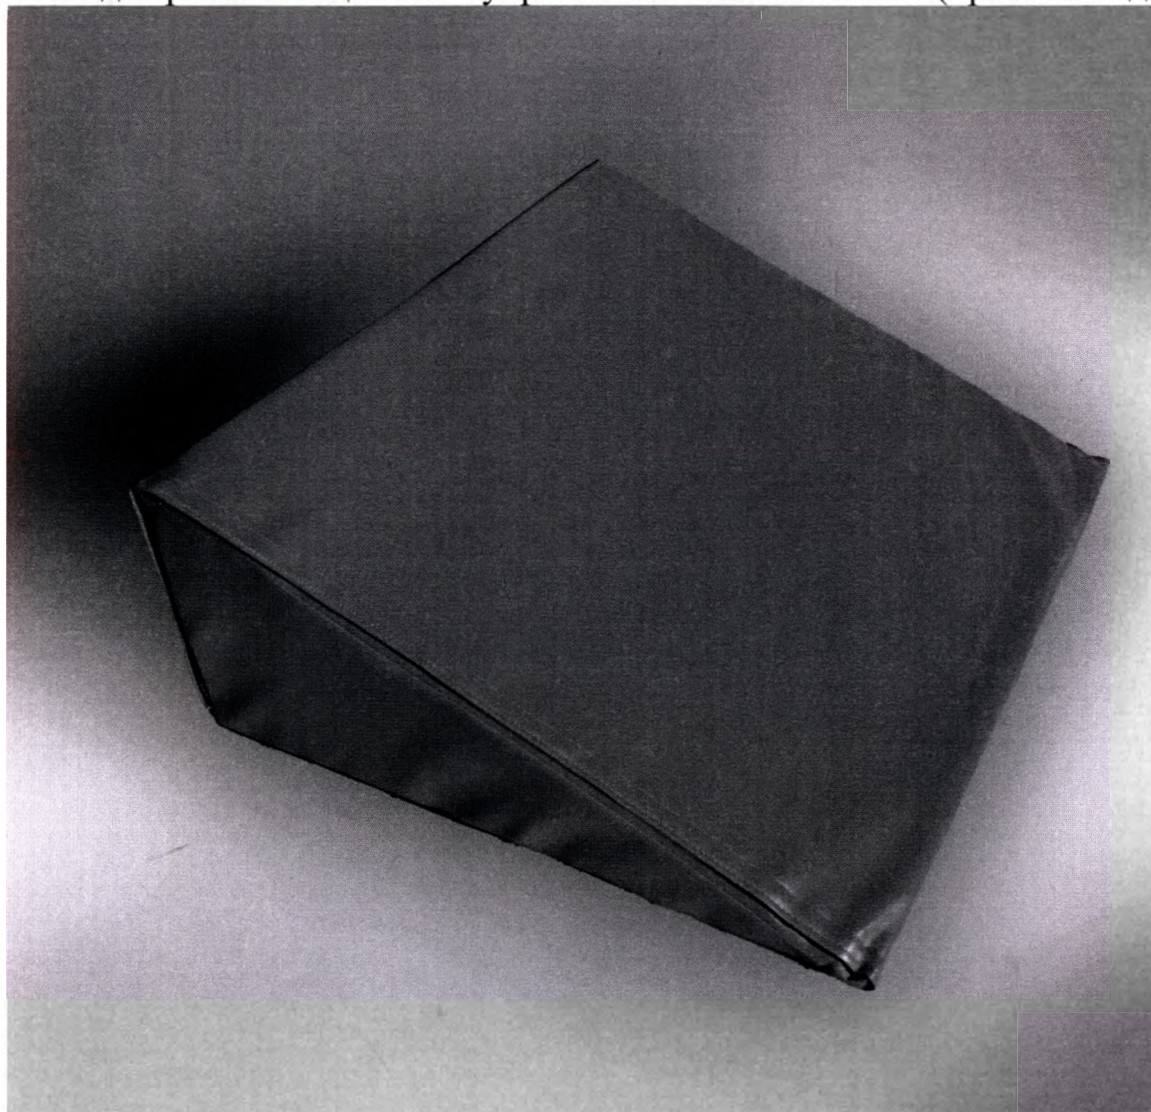


ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д. 39, кв. 64
Стоп массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Клин для реабилитационных упражнений
25 x 60 x 70 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Клин для реабилитационных упражнений 20 x 35 x 50 см (при необходимости)

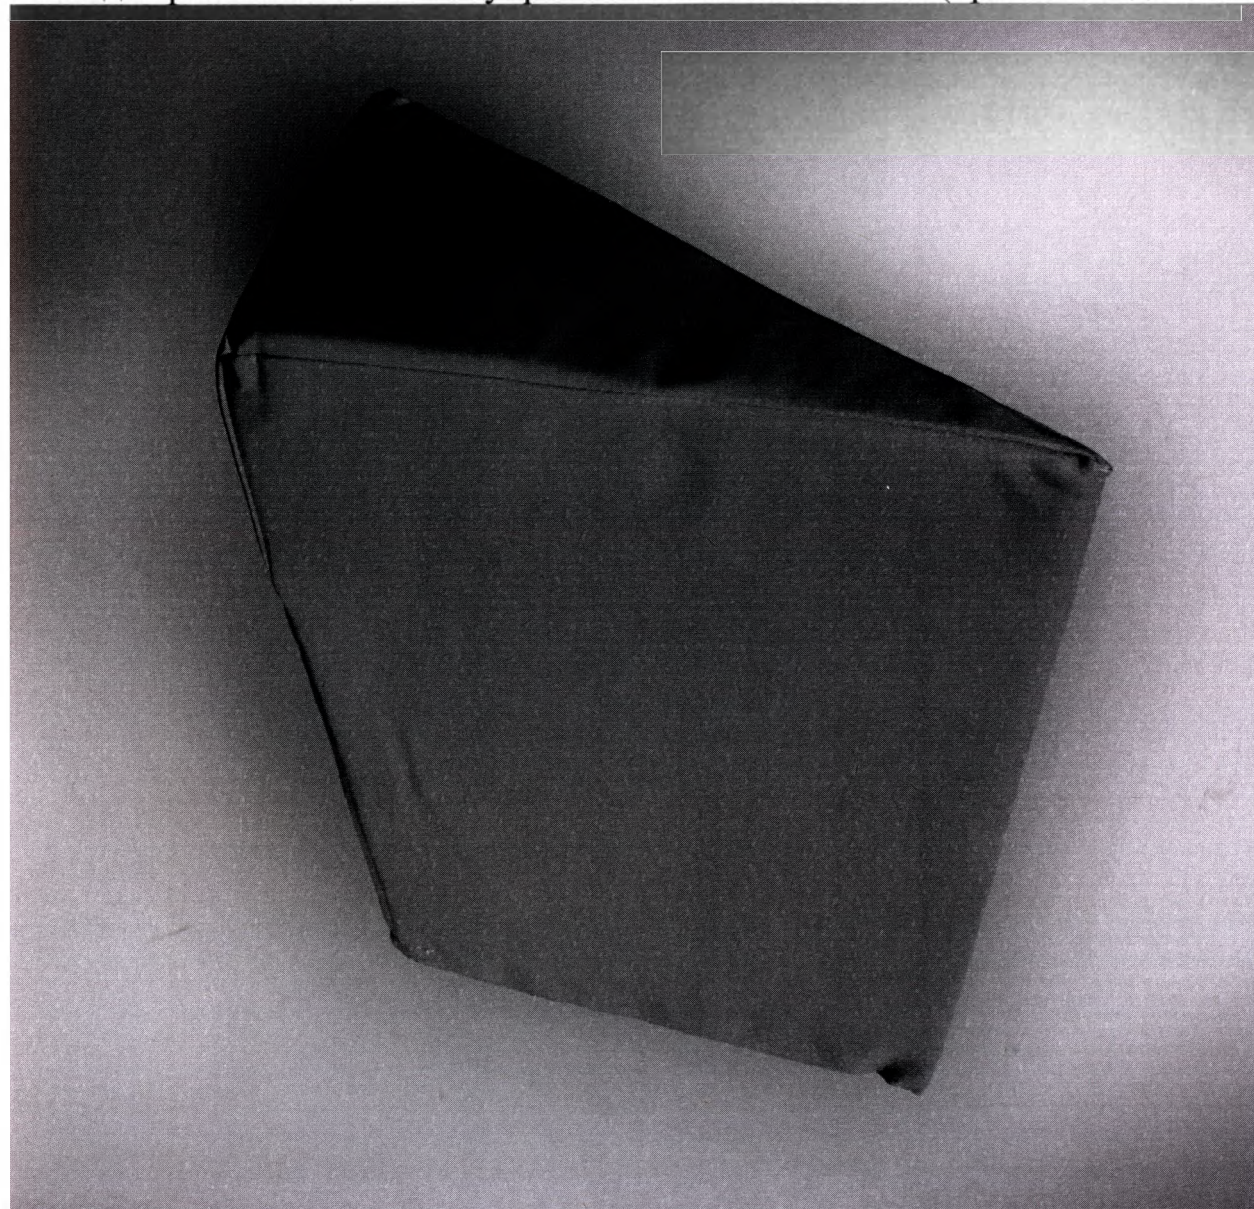

ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д. 39, кв. 64

Стоп массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Клин для реабилитационных упражнений
20 x 35 x 50 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Валик для реабилитационных упражнений ø 50 x 100 см (при необходимости)



ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д. 39, кв. 64

Стол массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Валик для реабилитационных упражнений
ø 50 x 100 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Валик для реабилитационных упражнений ø 25 x 100 см (при необходимости)



ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64


Стол массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Валик для реабилитационных упражнений
ø 25 x 100 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Валик для реабилитационных упражнений ø 20 x 60 см (при необходимости)

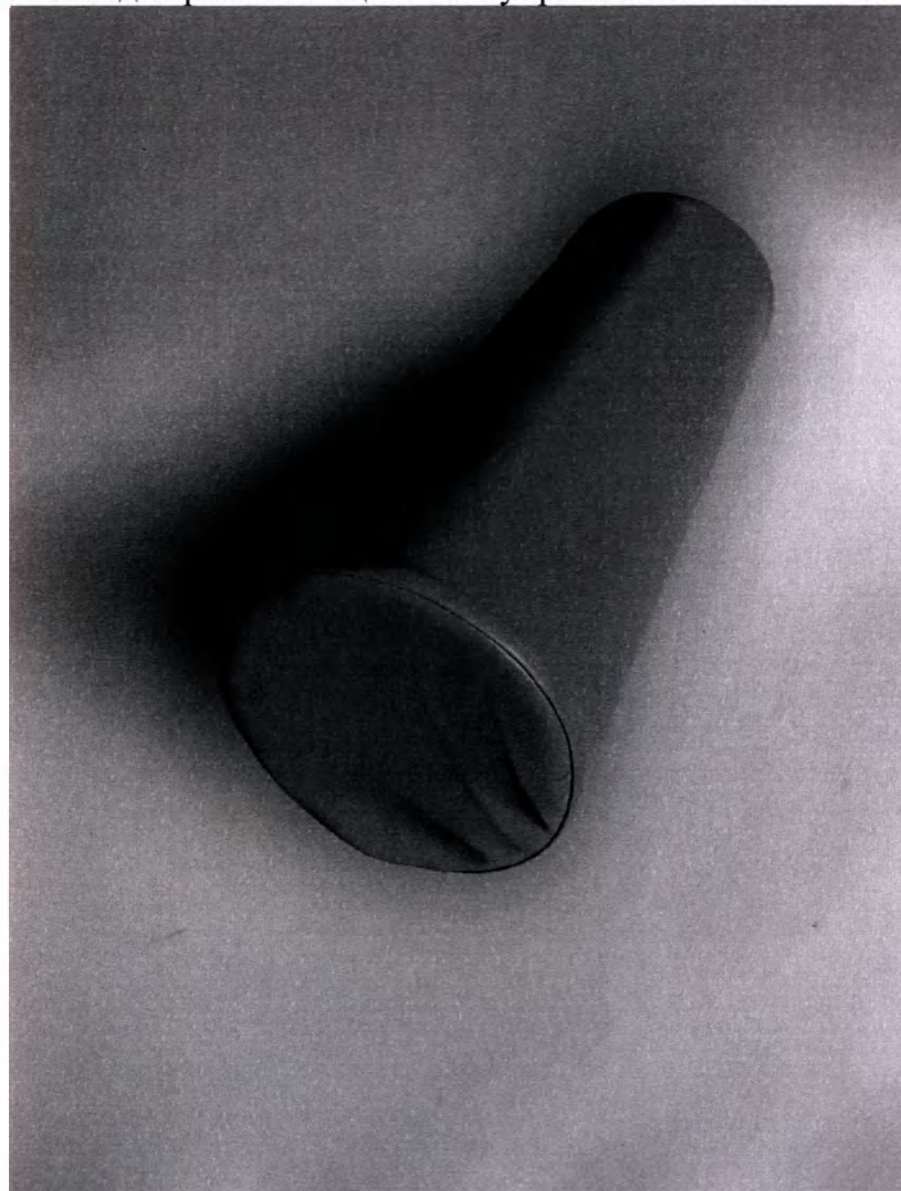

ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64

Стол массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Валик для реабилитационных упражнений
ø 20 x 60 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Валик для реабилитационных упражнений $\varnothing$ 15 x 60 см (при необходимости)



ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д. 39, кв. 64

Стоп массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32 50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Валик для реабилитационных упражнений
 $\varnothing$ 15 x 60 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Полувалик для реабилитационных упражнений 10 x 15 x 60 см (при необходимости)




ООО НПФ «Реабилитационные технологии»,
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д. 39, кв. 64
Стол массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Полувалик
для реабилитационных упражнений
10 x 15 x 60 см**

Серийный номер:


Дата изготовления:

Полувалик для реабилитационных упражнений 15 x 15 x 60 см (при необходимости)

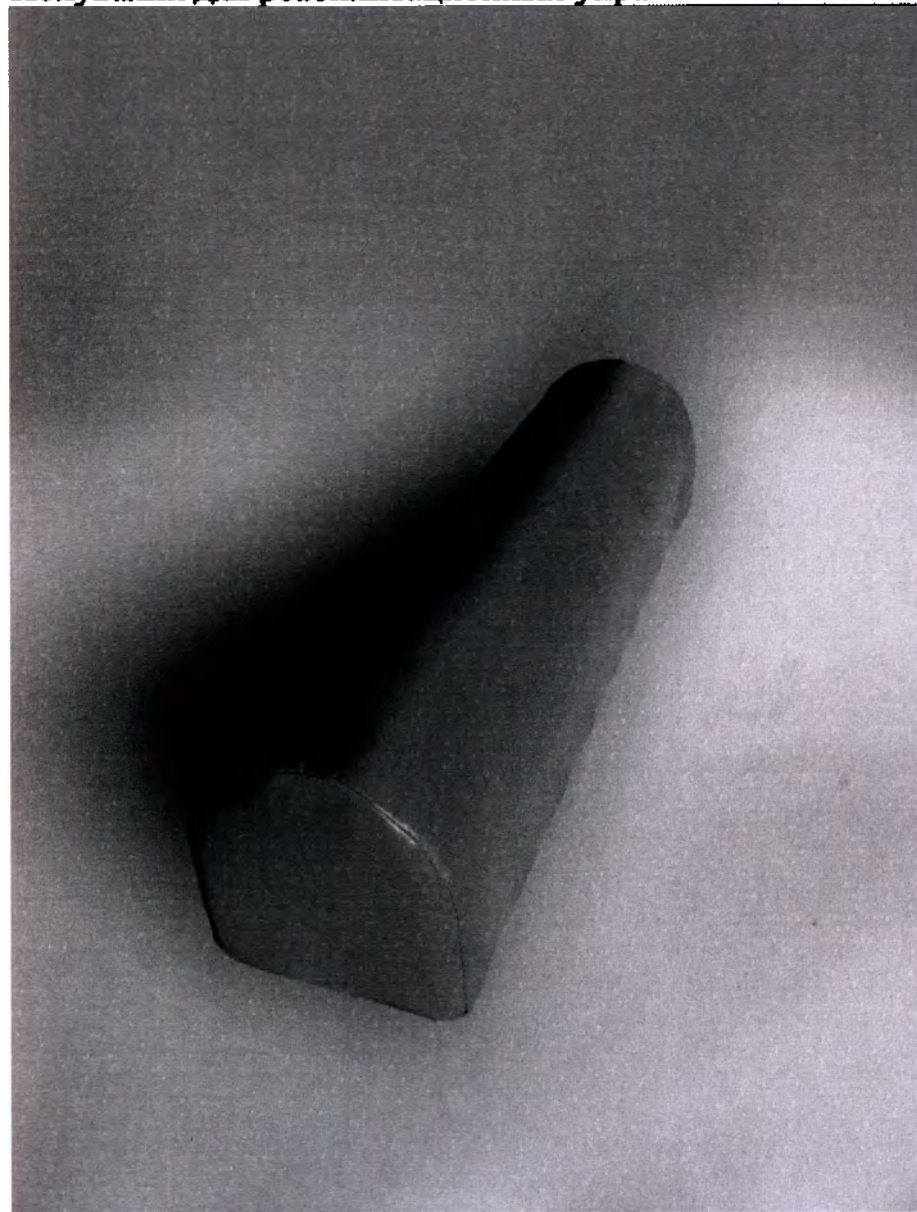


ООО НПО «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Милославского Н. Я., д.39, кв.64	
Стоп массовый паразитический "Юнко-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-66706706-2023. в вариантах исполнения	
Полувалик для реабилитационных упражнений 15 x 15 x 60 см	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Ремень для фиксации тела (при необходимости)

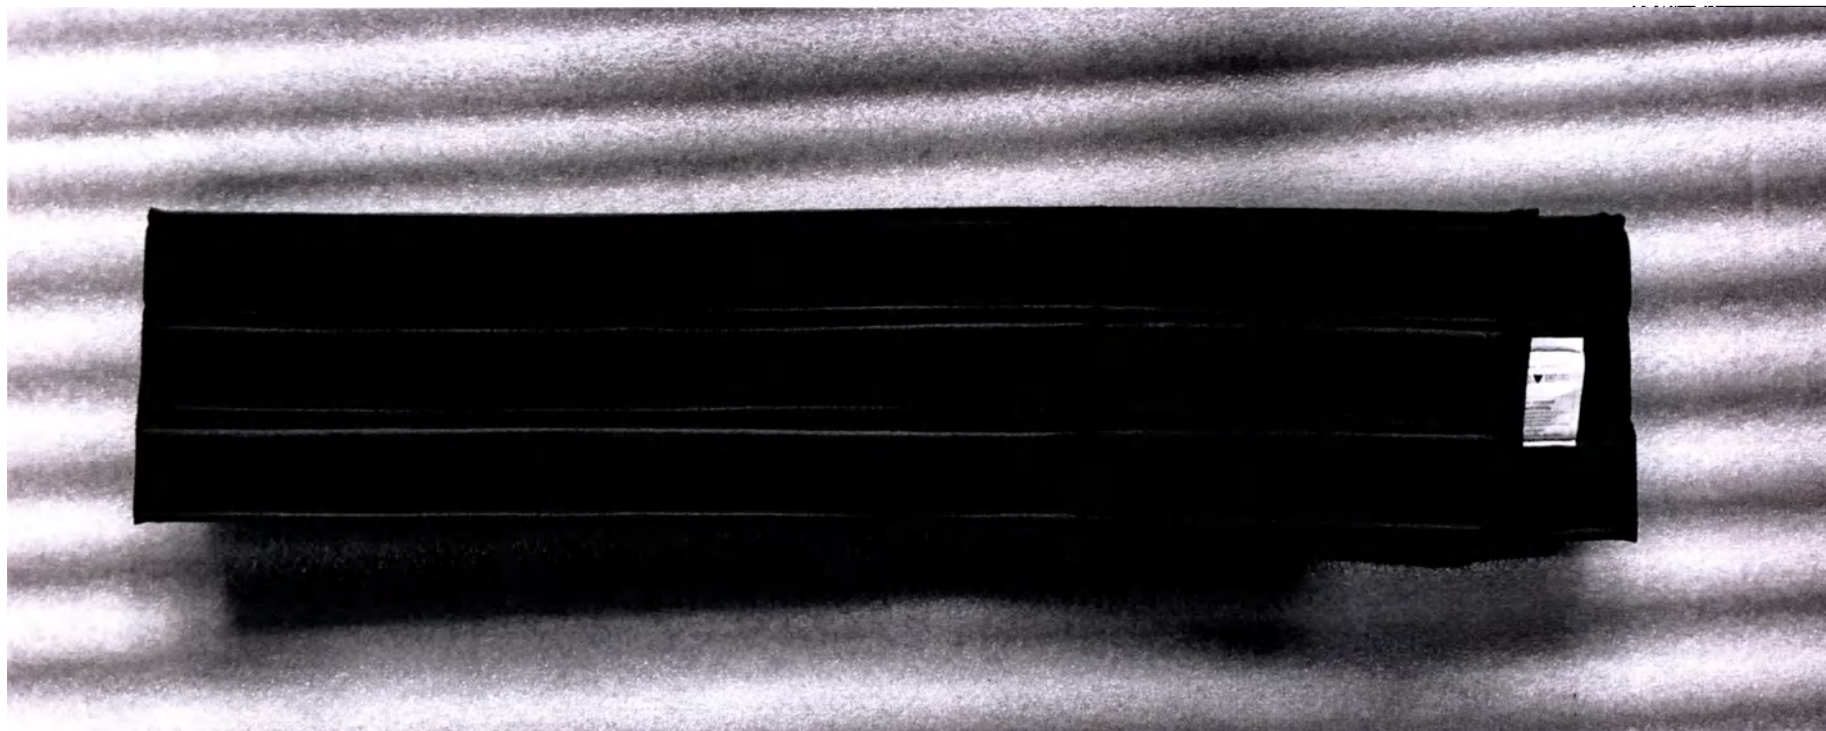


ООО ЦИРМИ «Республиканское предприятие Россия, 600126, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Гавриила Милославского М. Д., д.38, кв.64	
Стен массовый промышленный «Микро-Эксперт» по ТУ 32.30.30-005-0570070-0003, в соответствии с требованиями	
Ремень для фиксации тела 10 x 255 см	
стирка с мылом, сушка по цвету	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Ремень для фиксации ног (при необходимости)

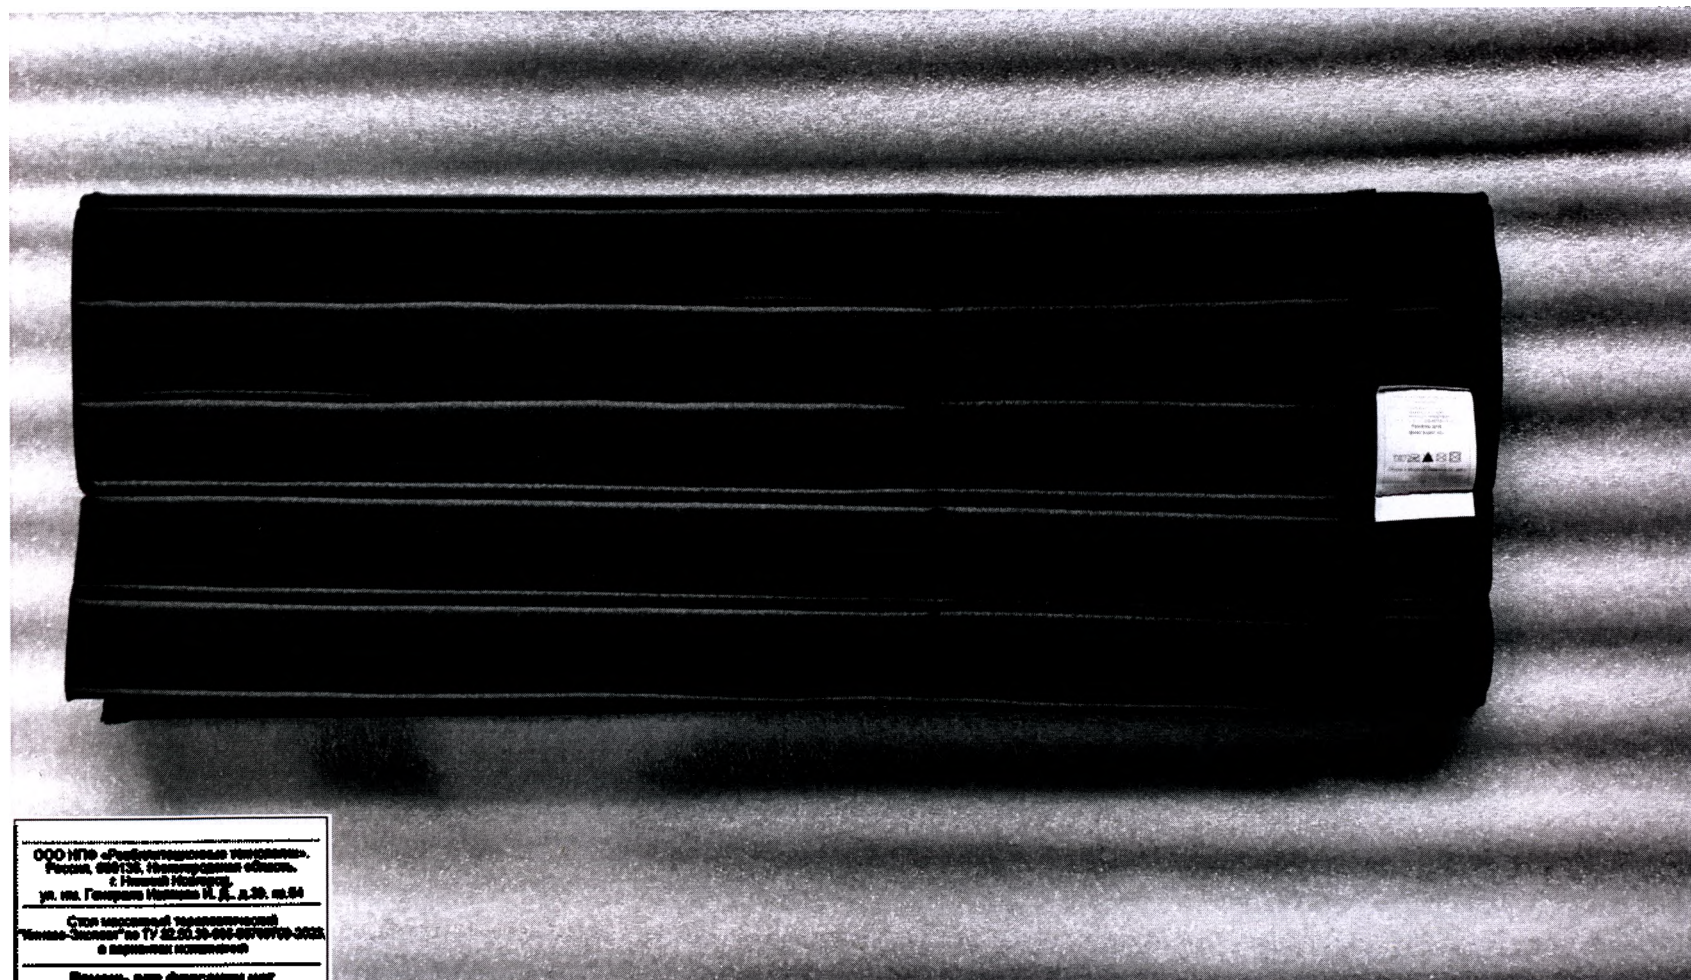

ООО НПО «Российские технологии» Россия, 600126, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Гавриила Никитина 11, д. 30, эт. 54	
Сайт интернет-телевизионный "Нижнее-Волжье" по ТУ 62.05.30-000-0070700-0020 с параметрами кодирования	
Ремень для фиксации ног 20 x 200 см	
Стирать с замочком, исключая по цвету	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Жёсткая опора для фиксации тела пациента (при необходимости)

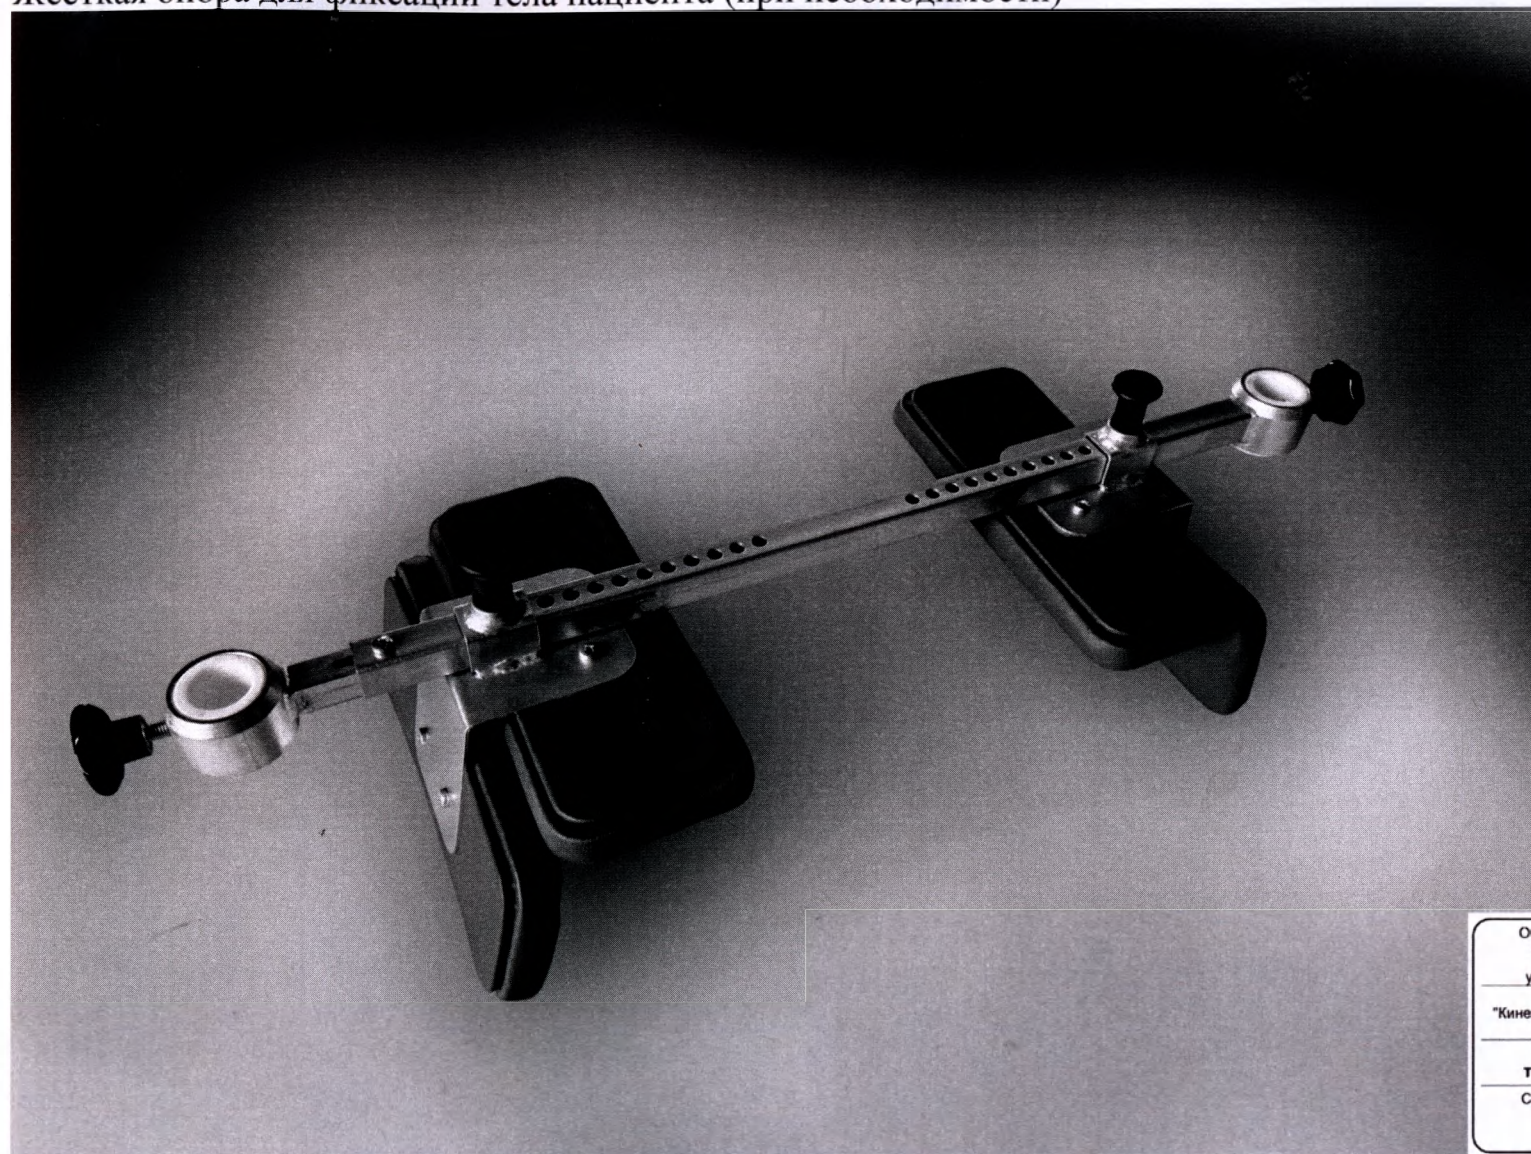

ООО НПФ «Реабилитационные технологии».
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д. 39, кв. 64

Стоп массажный терапевтический
"Кинезо-Эксперт" по ТУ 32.50.30-006-68709709-2023,
в вариантах исполнения

**Жёсткая опора для фиксации
тела пациента 22,3 x 28,4 x 82,5 см**

Серийный номер:

Дата изготовления:

ООО НПФ Реабилитационные технологии

Количество тридцать две

(32) листов

Директор

Емельянов А.В.

