

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ «Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения»

(Общество с ограниченной ответственностью «Ассомедика»)



Рисунок 1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F без тепловлагообмена

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РБ),
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125

**Фильтр дыхательный бактериально-
вирусный однократного применения
электростатический с размерами
выходов 22M/15F-15M/22F без
тепловлагообмена.**

Тип: взрослый

STERILE EO LOT F - 084

04/2017 04/2022

НЕТОКСИЧНО

**+40°C
+5°C
80%
0%**

ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

Рисунок 1.1. Маркировка Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F без тепловлагообмена



Рисунок 2. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F без тепловлагообмена, с портом luer-lock.

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РБ),
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125

**Фильтр дыхательный бактериально-
вирусный однократного применения
электростатический с размерами
выходов 22M/15F-15M/22F без
тепловлагообмена, с портом luer-lock.**

Тип: взрослый

STERILE EO LOT F - 084

04/2017 04/2022

   **НЕТОКСИЧНО**

ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

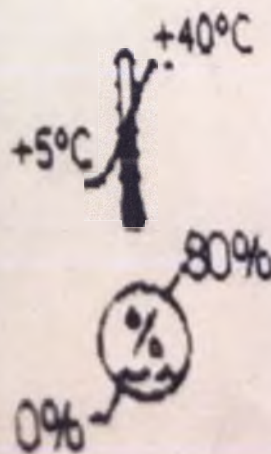


Рисунок 2.1. Маркировка Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F без тепловлагообмена, с портом luer-lock.



Рисунок 3. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F с тепловлагообменом

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РБ),
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125

**Фильтр дыхательный бактериально-
вирусный однократного применения
электростатический с размерами
выходов 22М/15F-15М/22F с
тепловлагообменом**


Тип: взрослый

STERILE EO LOT F - 084

04/2017 04/2022



НЕТОКСИЧНО

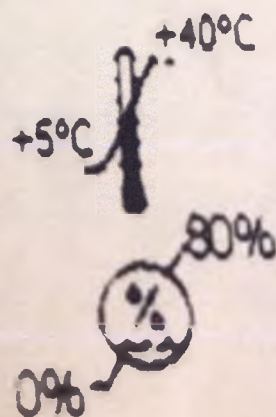

ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

исунок 3. 1 Маркировка. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения
электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F с тепловлагообменом




Рисунок 4. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РБ),
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125

Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F с тепловлагообменом, с портом luer-lock

Тип: взрослый


STERILE EO LOT F - 084

 04/2017  04/2022

   **НЕТОКСИЧНО**

ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

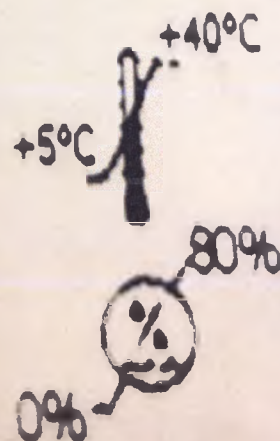

рисунк 4.1. Маркировка Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock

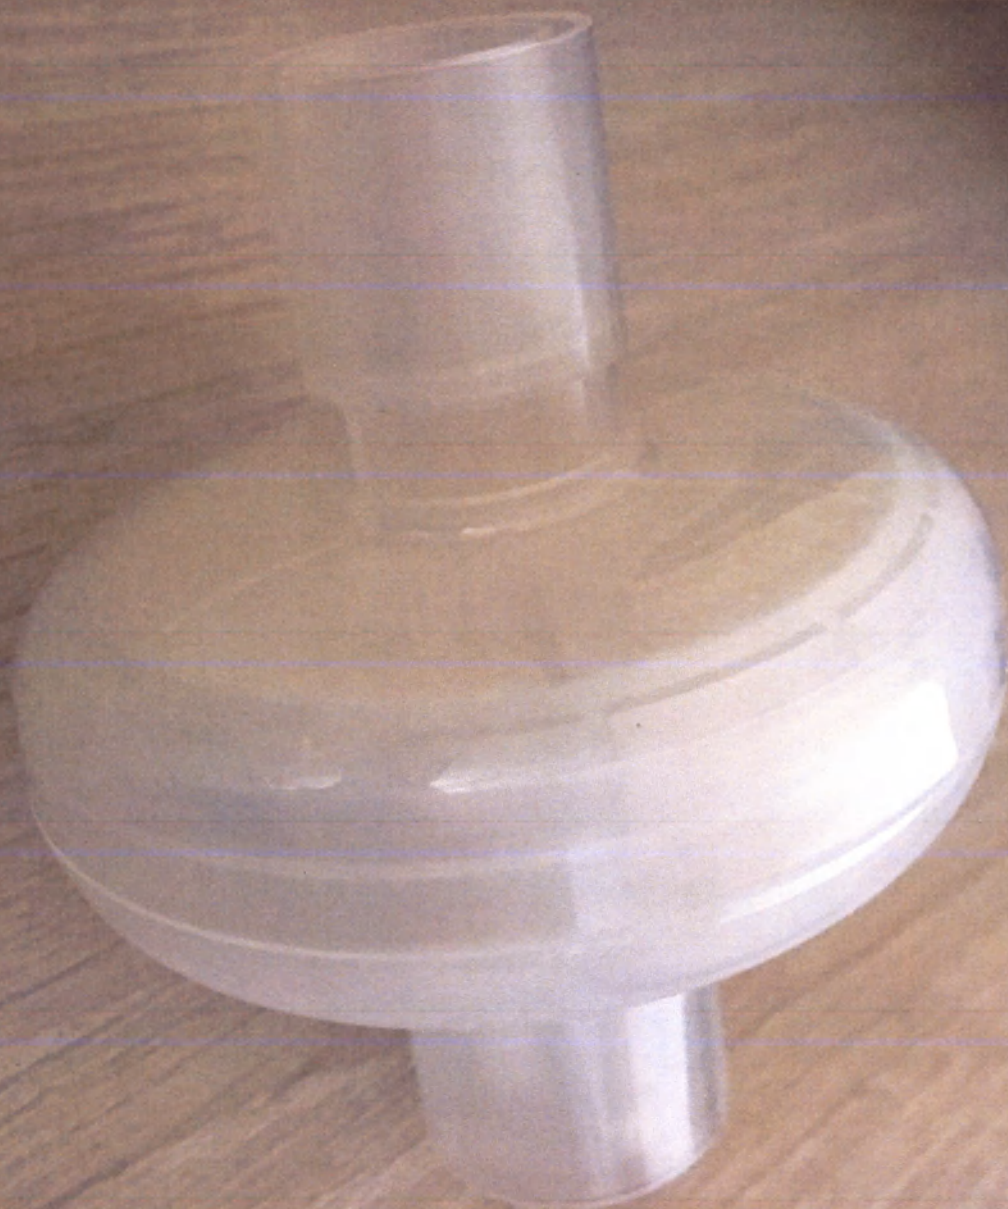


Рисунок 5. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F с тепловлагообменом

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РБ),
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125

Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F с тепловлагообменом

Тип: взрослый

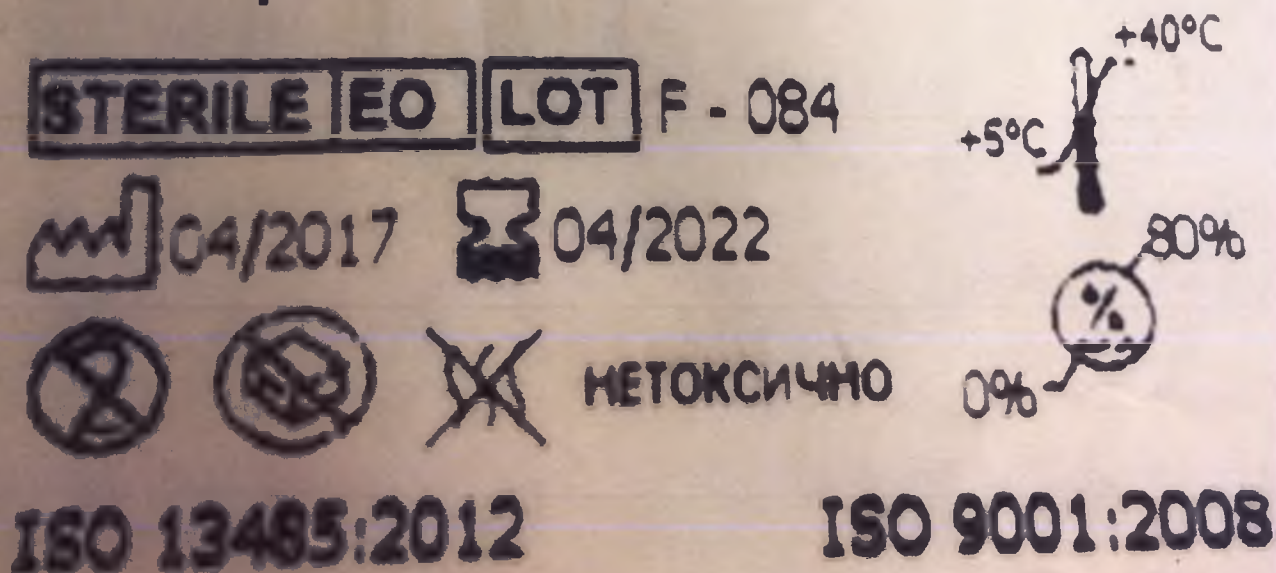


Рисунок 5.1. Маркировка Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F с тепловлагообменом



Рисунок 6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22 с теплообменом, с портом luer-lock

ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РБ),
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125

**Фильтр дыхательный бактериально-
вирусный однократного применения
механический с размерами выходов
22M/15F-15M/22F с тепловлагообменом
с портом luer-lock**


Тип: взрослый

STERILE EO LOT F - 084

04/2017 04/2022



НЕТОКСИЧНО

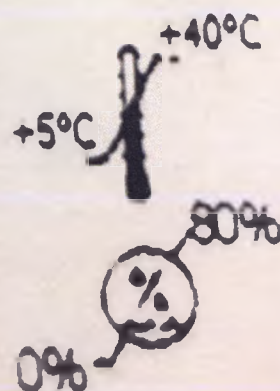

ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

Рисунок 6.1. Маркировка Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22M/15F-15M/22 с тепловлагообменом, с портом luer-lock



Рисунок 7. Соединитель угловой гибкий



Рисунок 8. Соединитель угловой

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 15 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова / Носова Т.А.
М.П.

