


«Иерсиния РПГА лиофилизат»



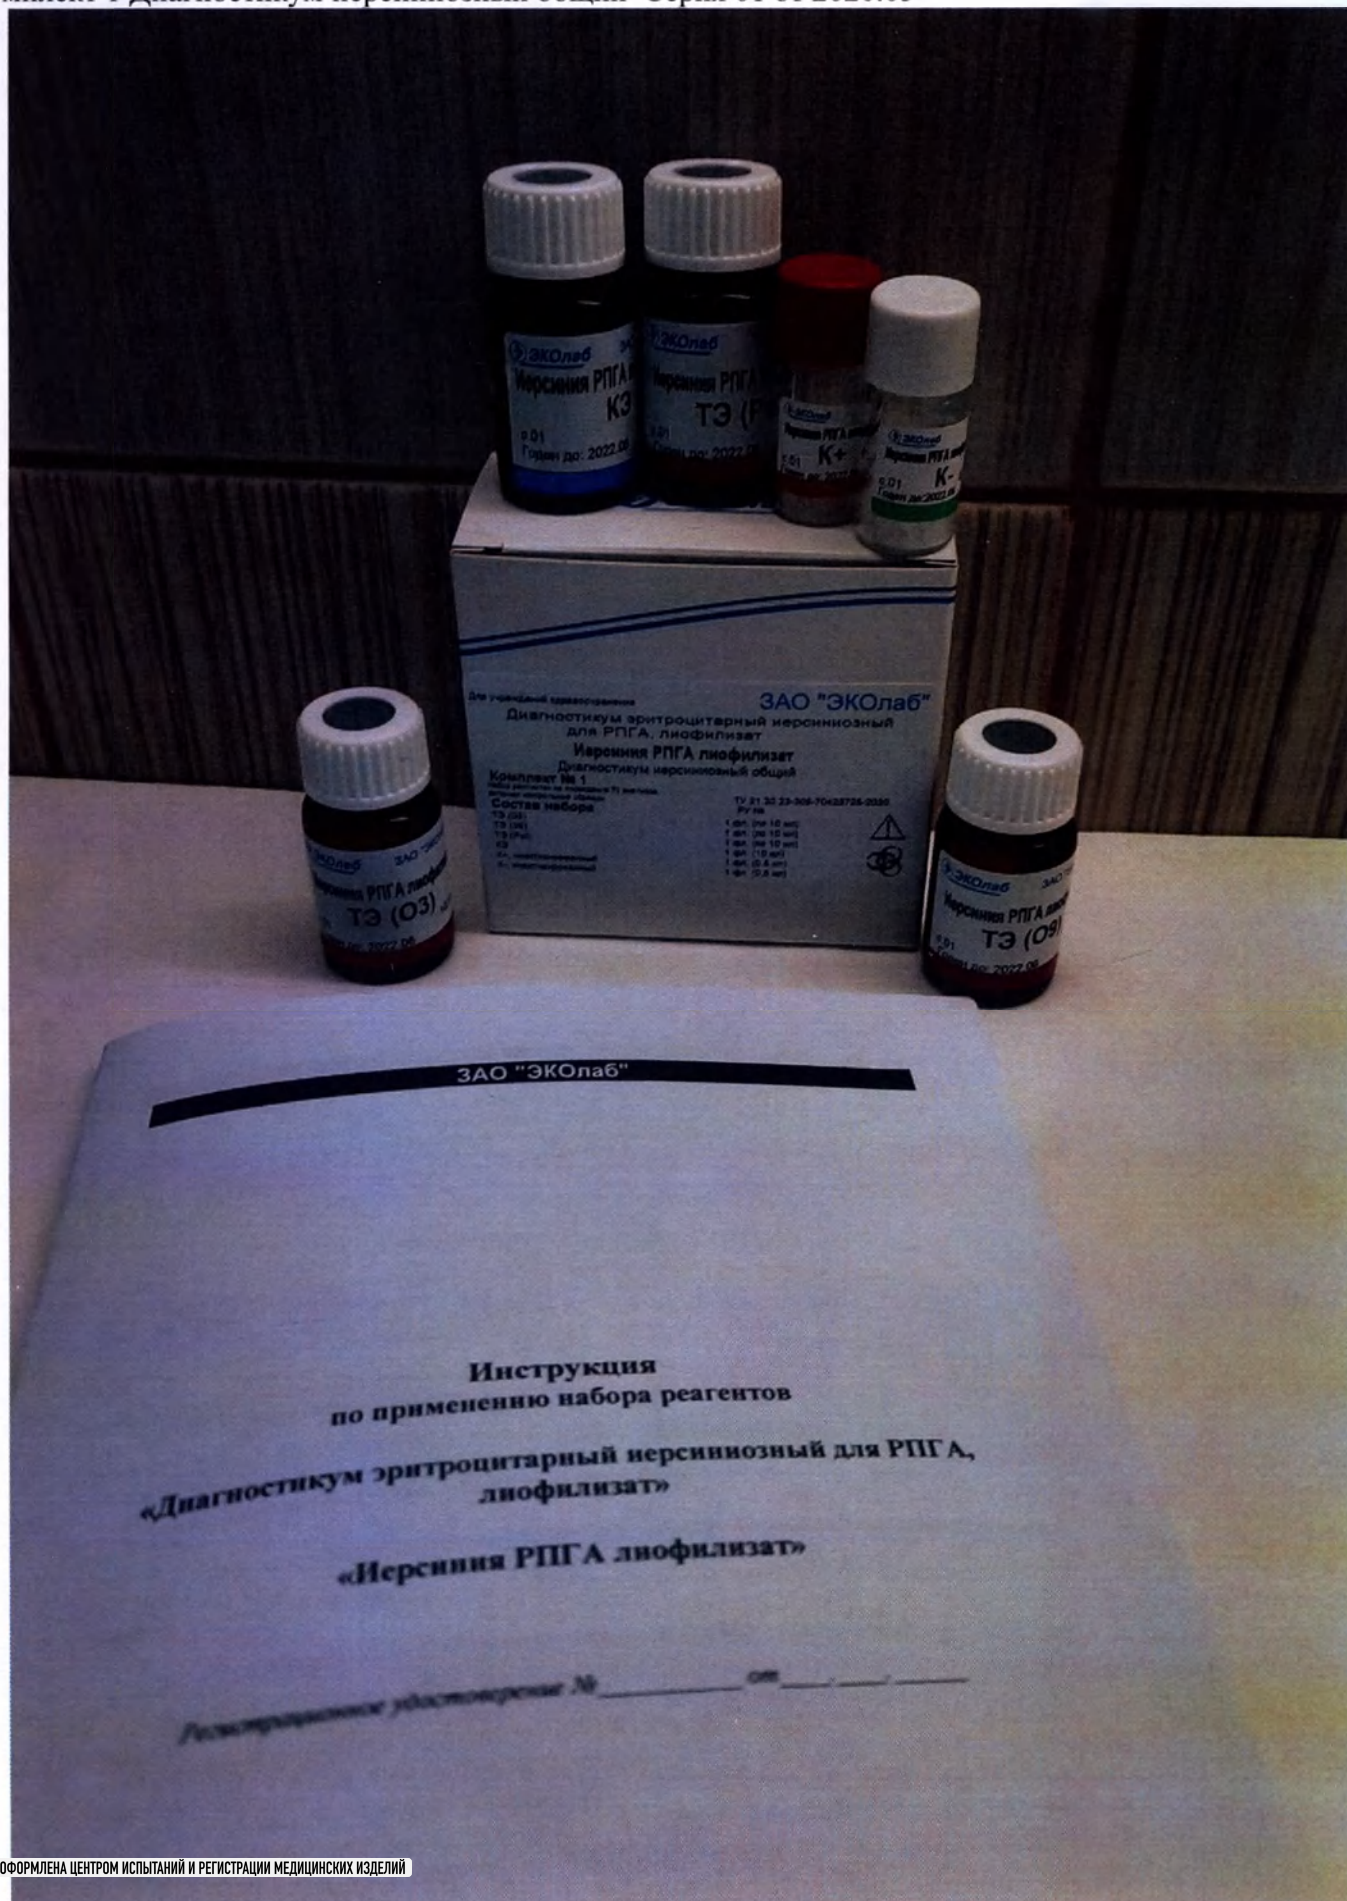

ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов
«Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный для РПГА,
лиофилизат»
«Иерсиния РПГА лиофилизат»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов
«Диагностикум эритроцитарный нерсиннозный для РПГА,
лиофилизат»
«Нерсиния РПГА лиофилизат»


Регистрационный удостоверение № _____




ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов
«Диагностикум эритроцитарный нерсиниозный для РПГА,
лиофилизат»
«Нерсиния РПГА лиофилизат»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

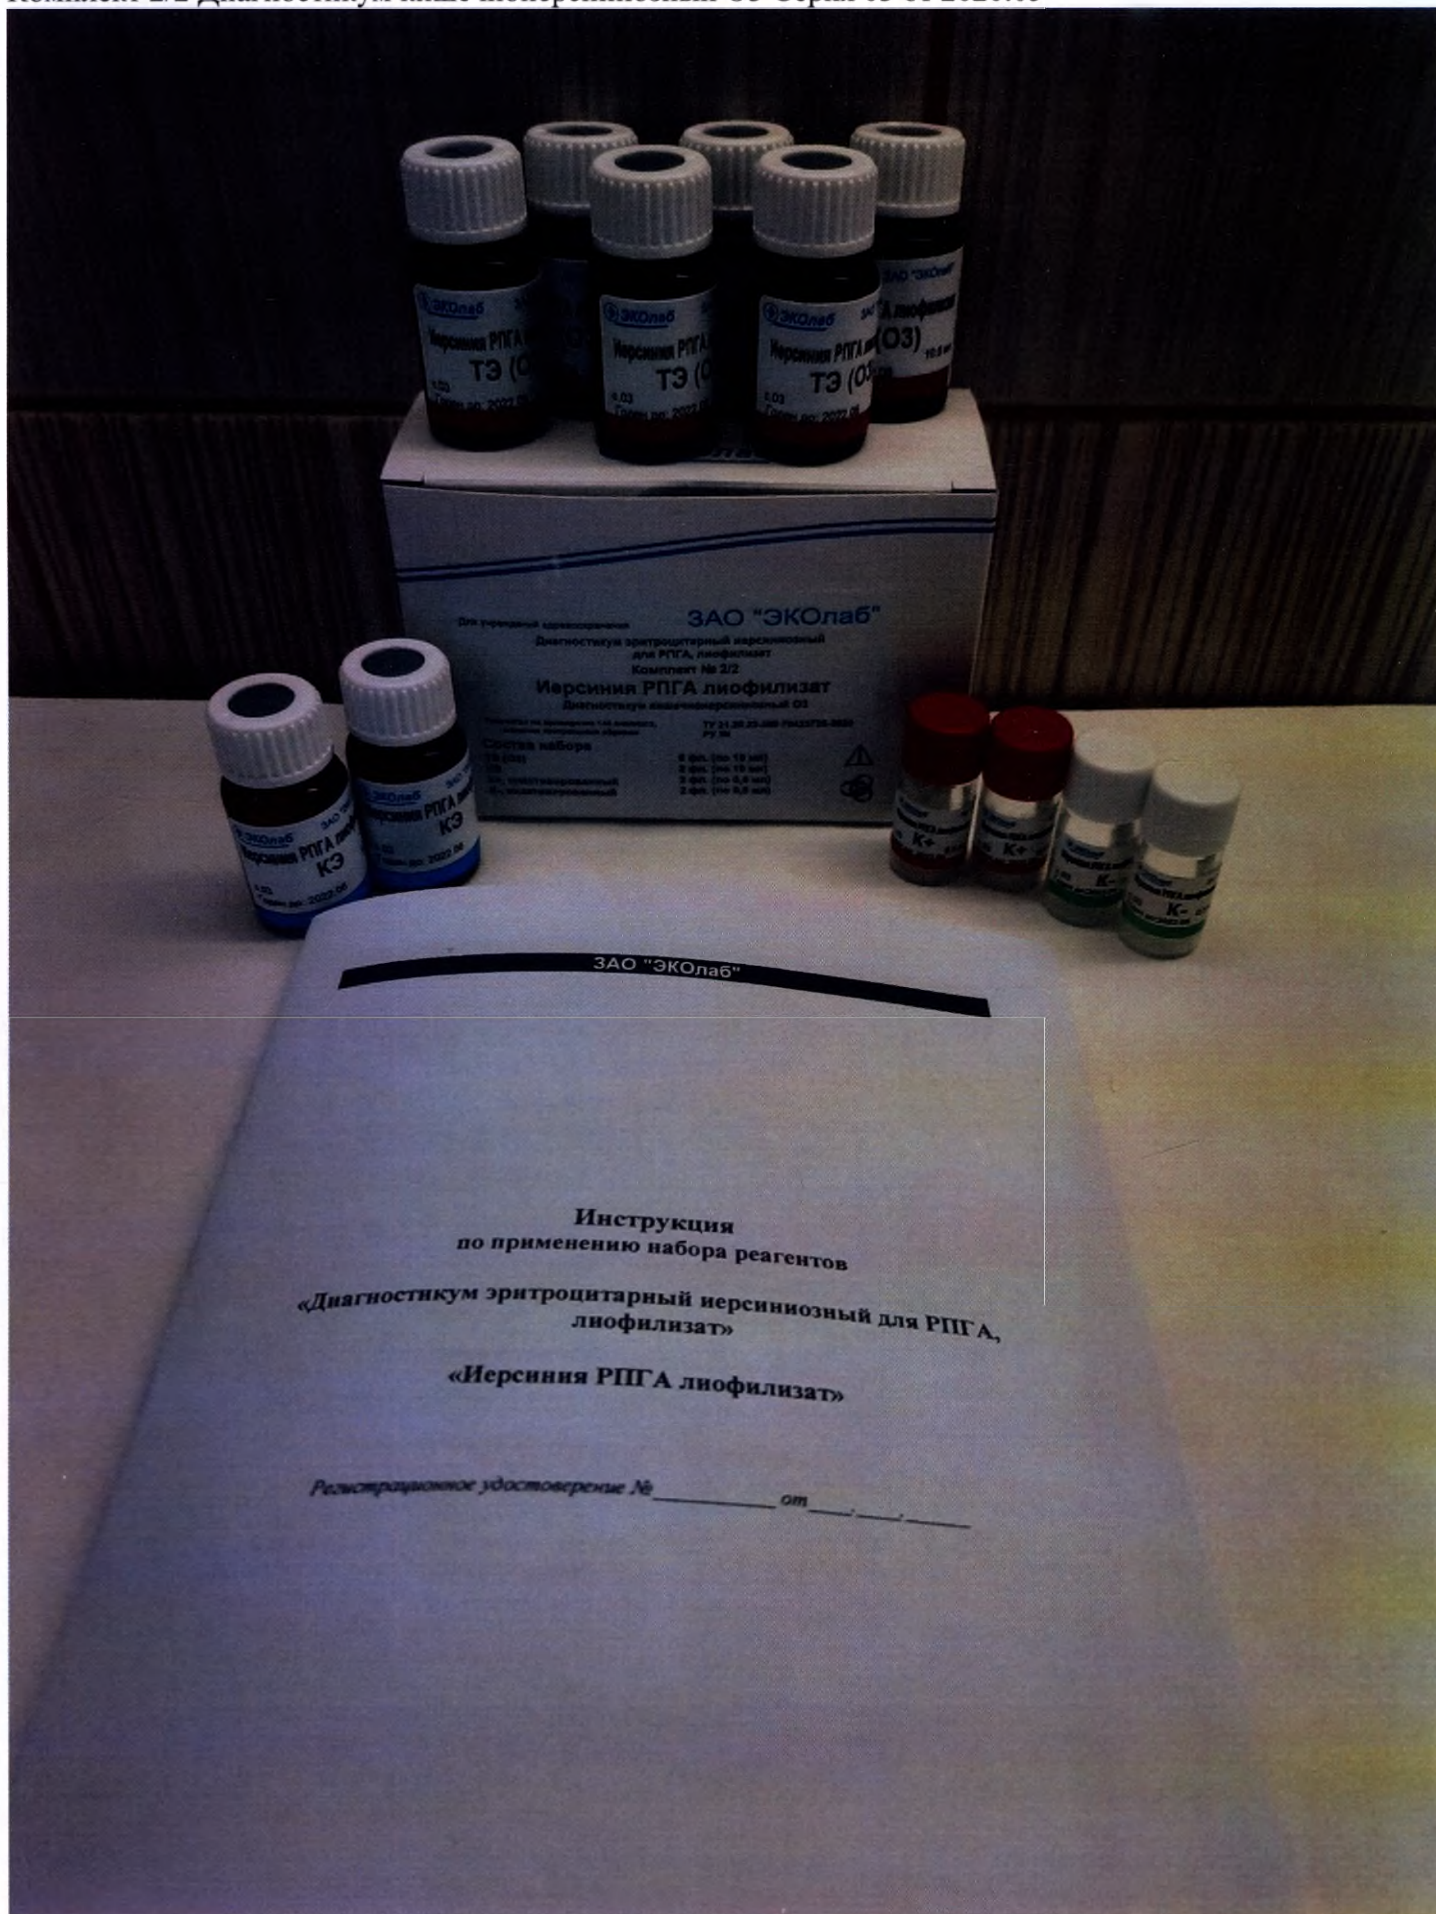




Регистрационный номер _____ от _____



ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов
«Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный для РПГА,
лиофилизат»
«Иерсиния РПГА-лиофилизат»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

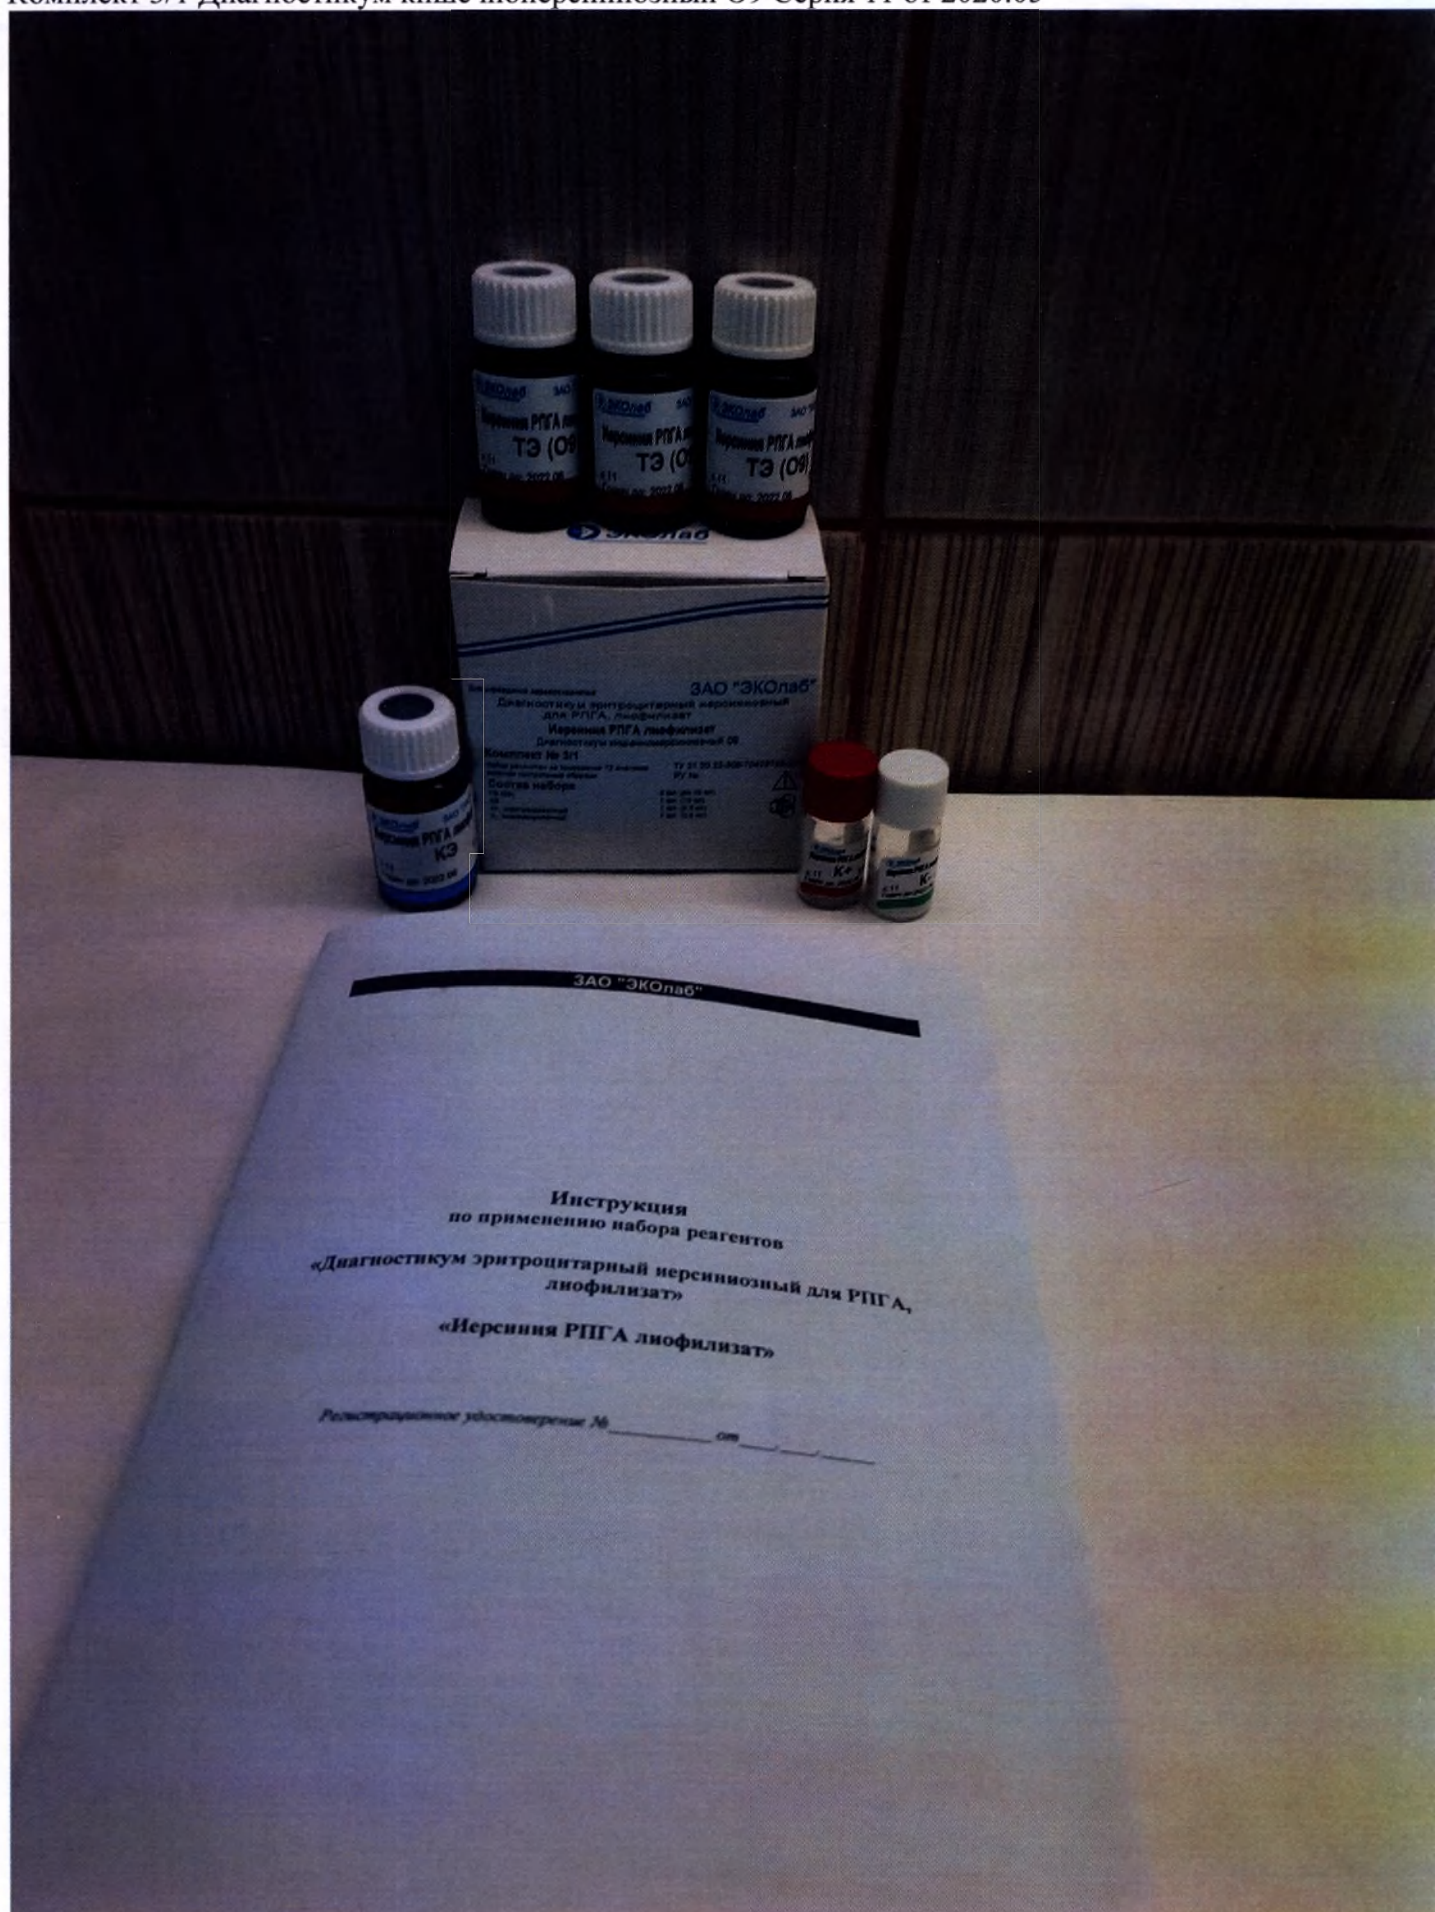






ЗАО "ЭКОЛаб"


Инструкция
по применению набора реагентов
«Диагностикум эритроцитарный нерсиниозный для РПГА,
лиофилизат»
«Нерсиния РПГА лиофилизат»


Регистрационный удостоверение № _____ от _____

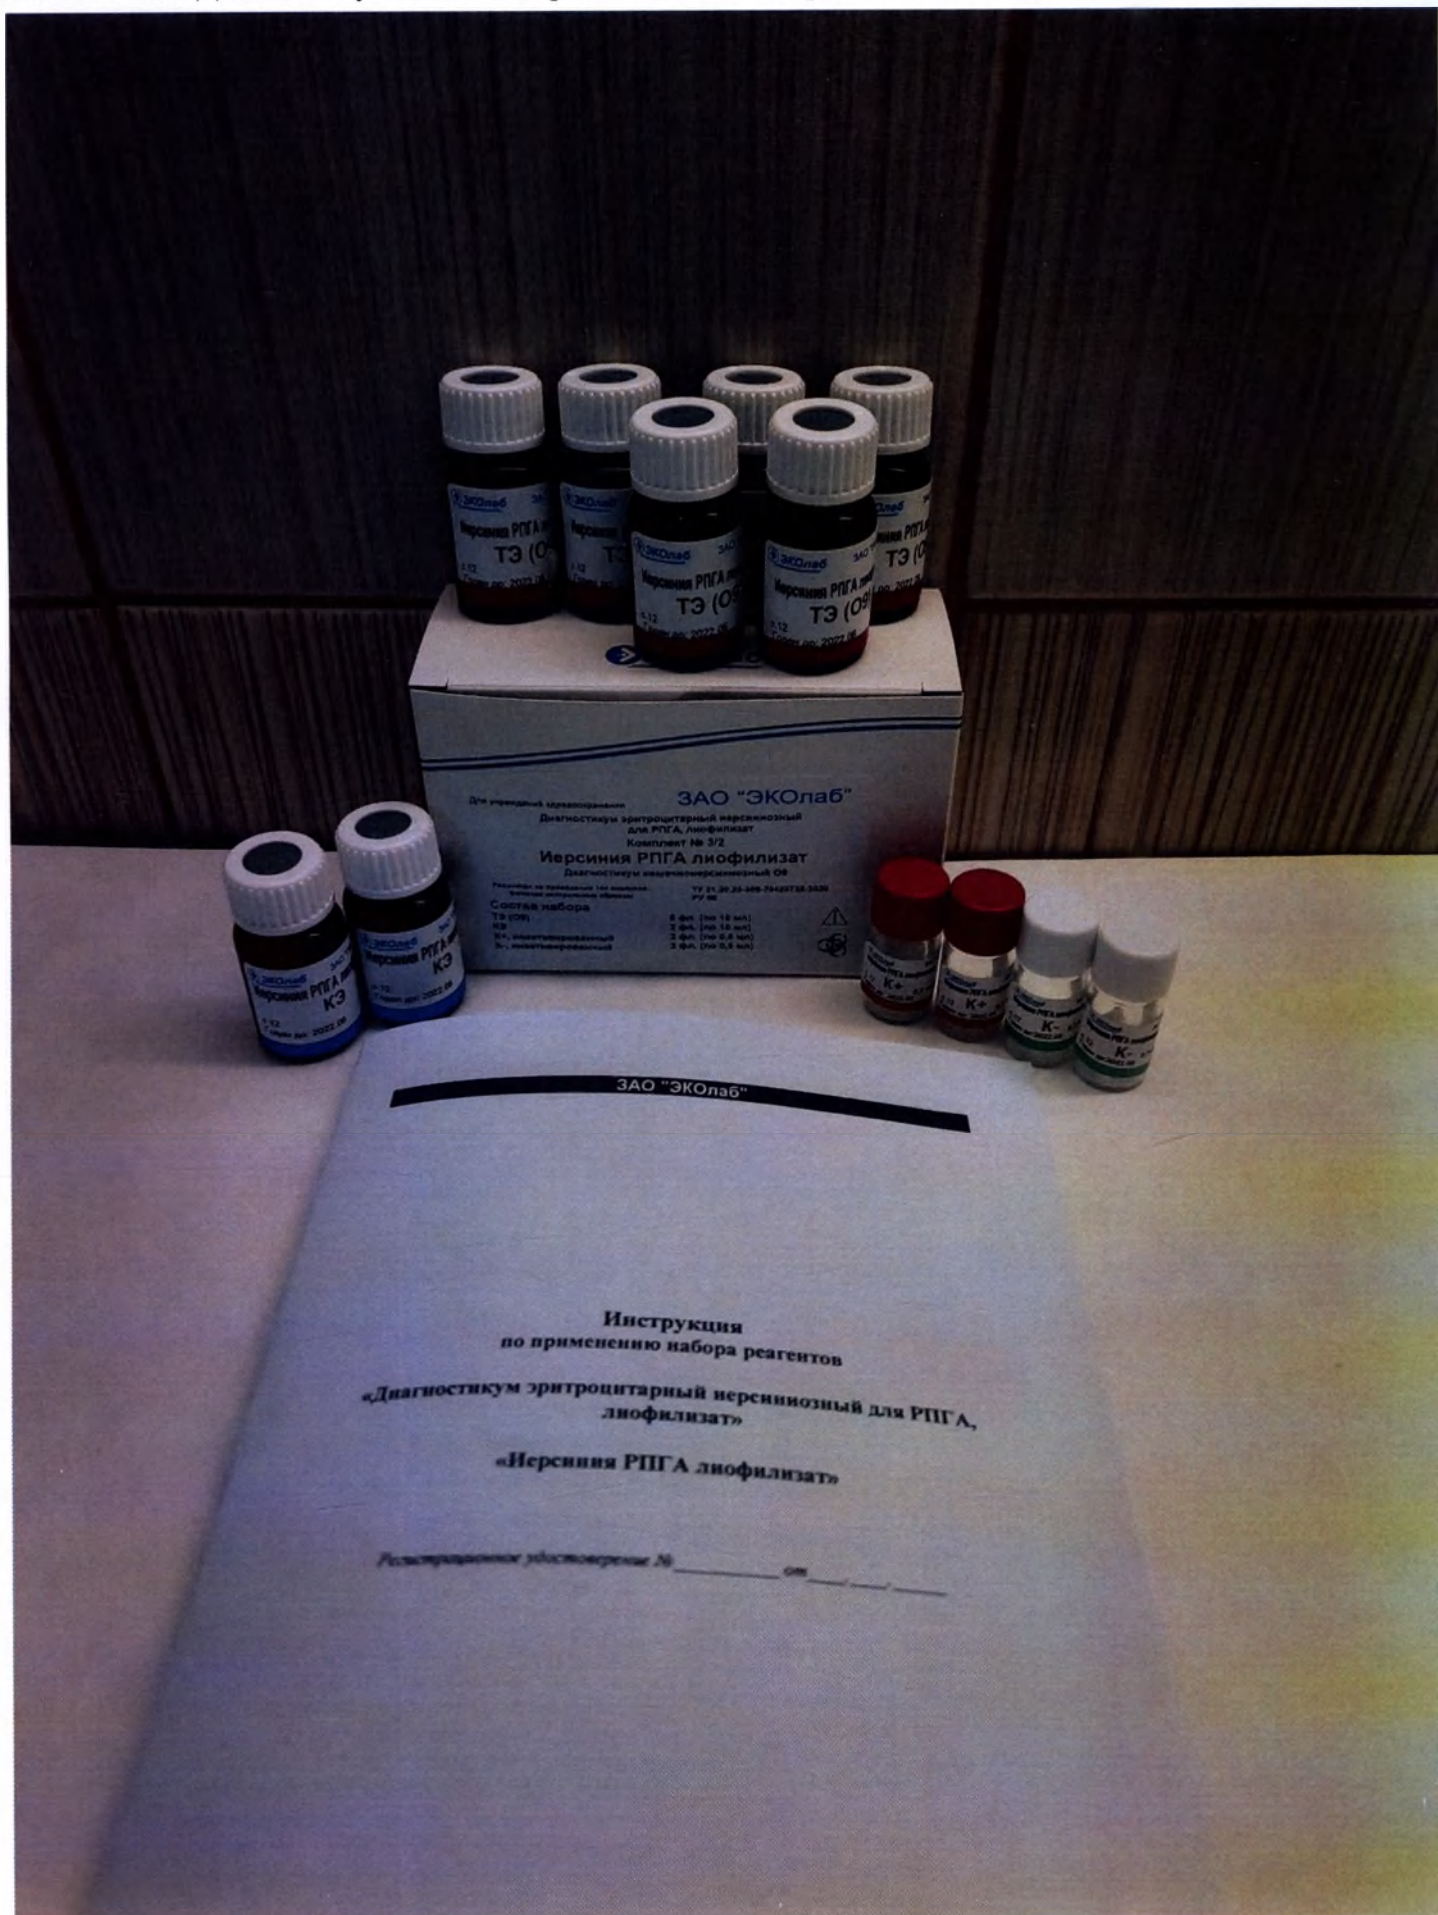

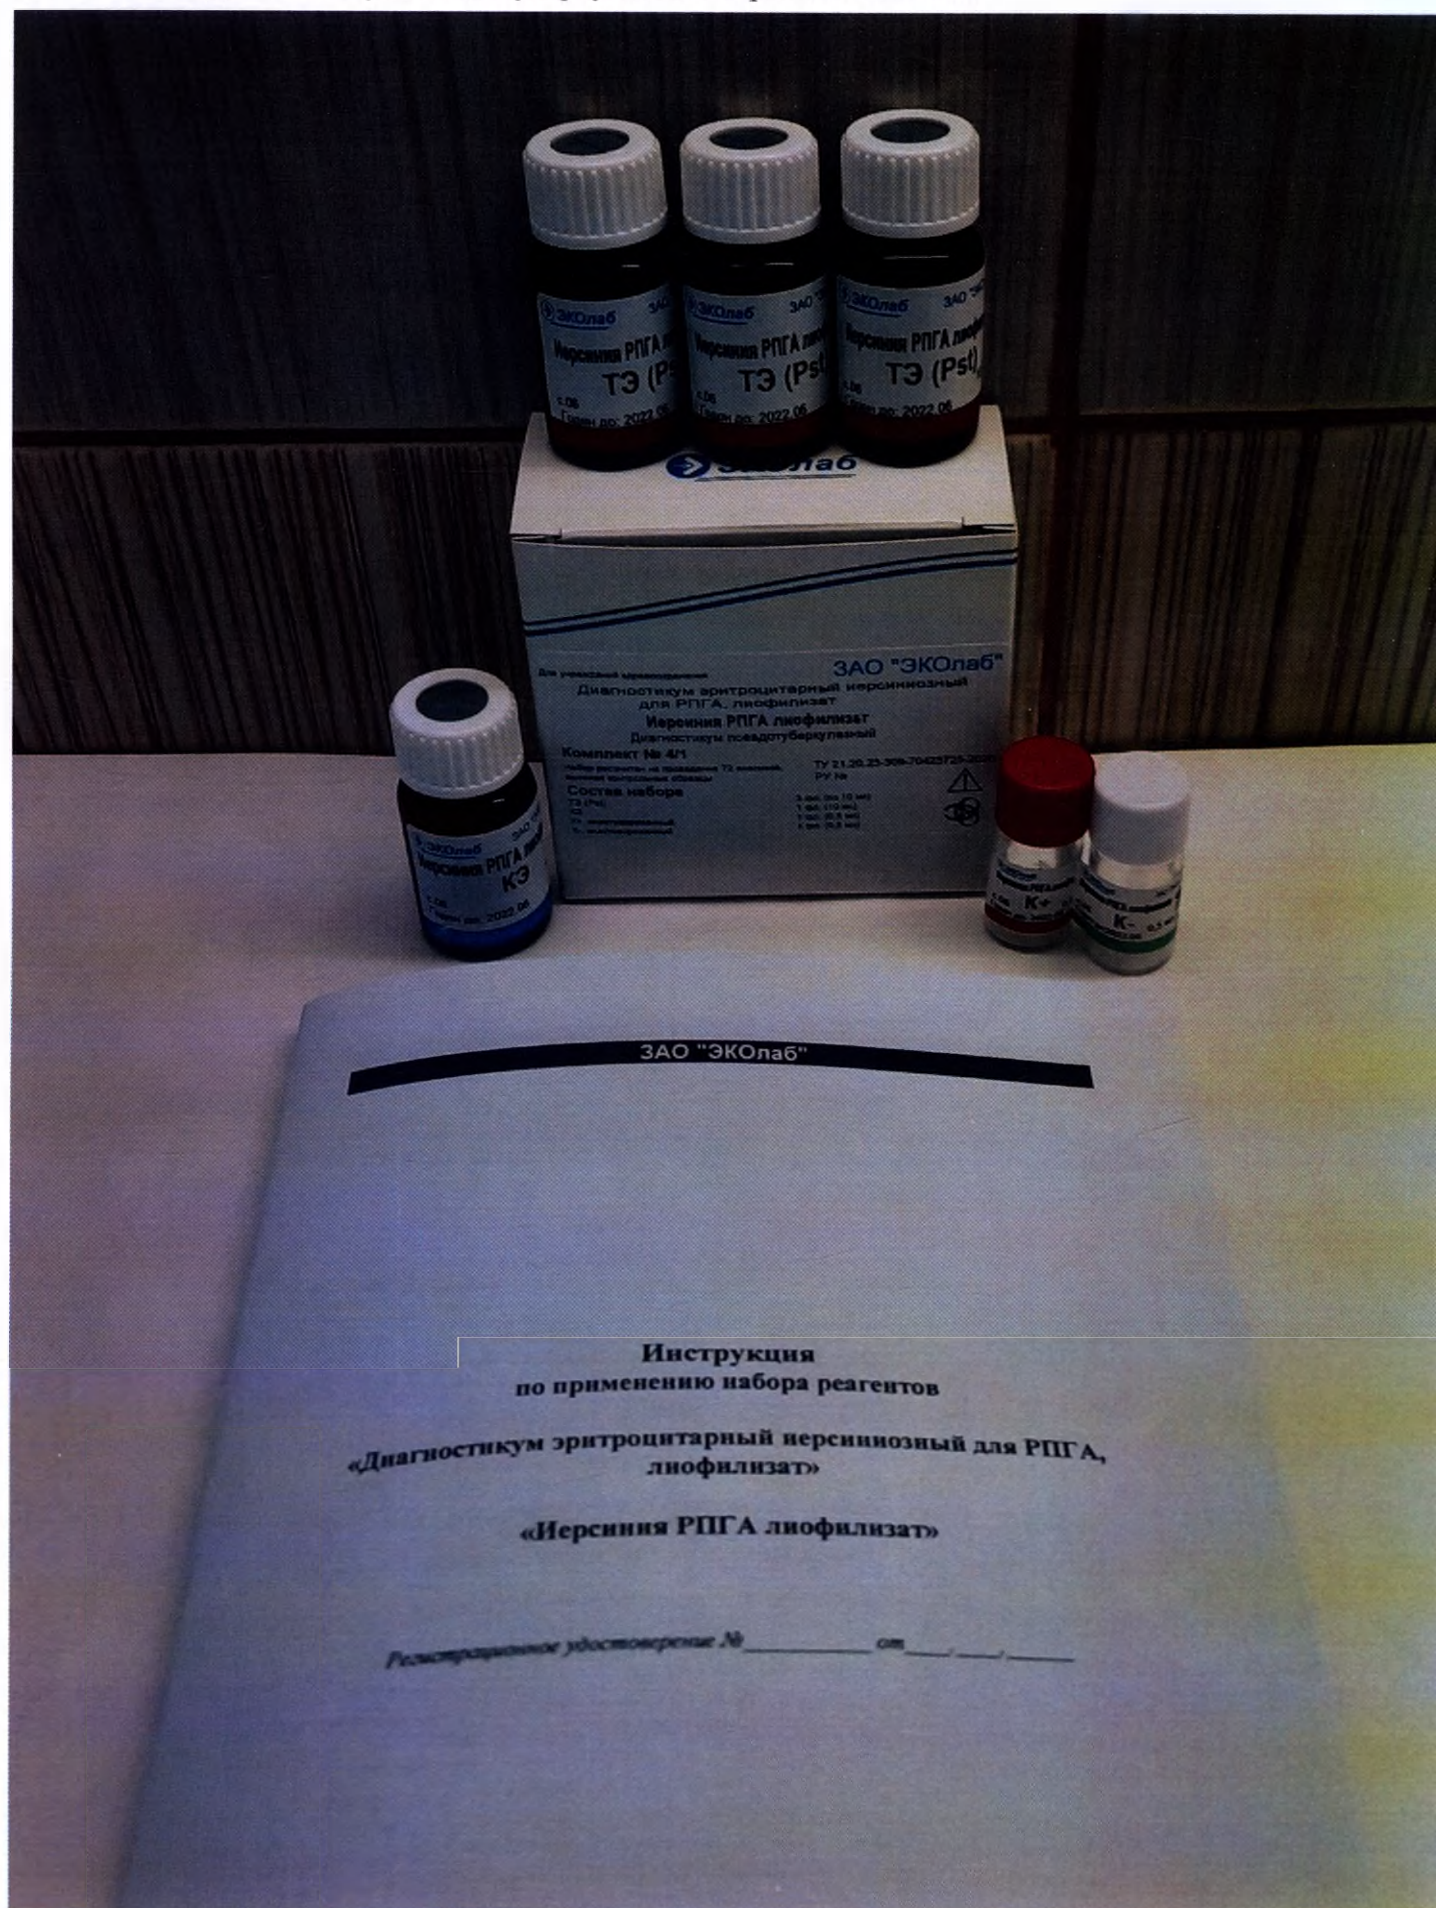

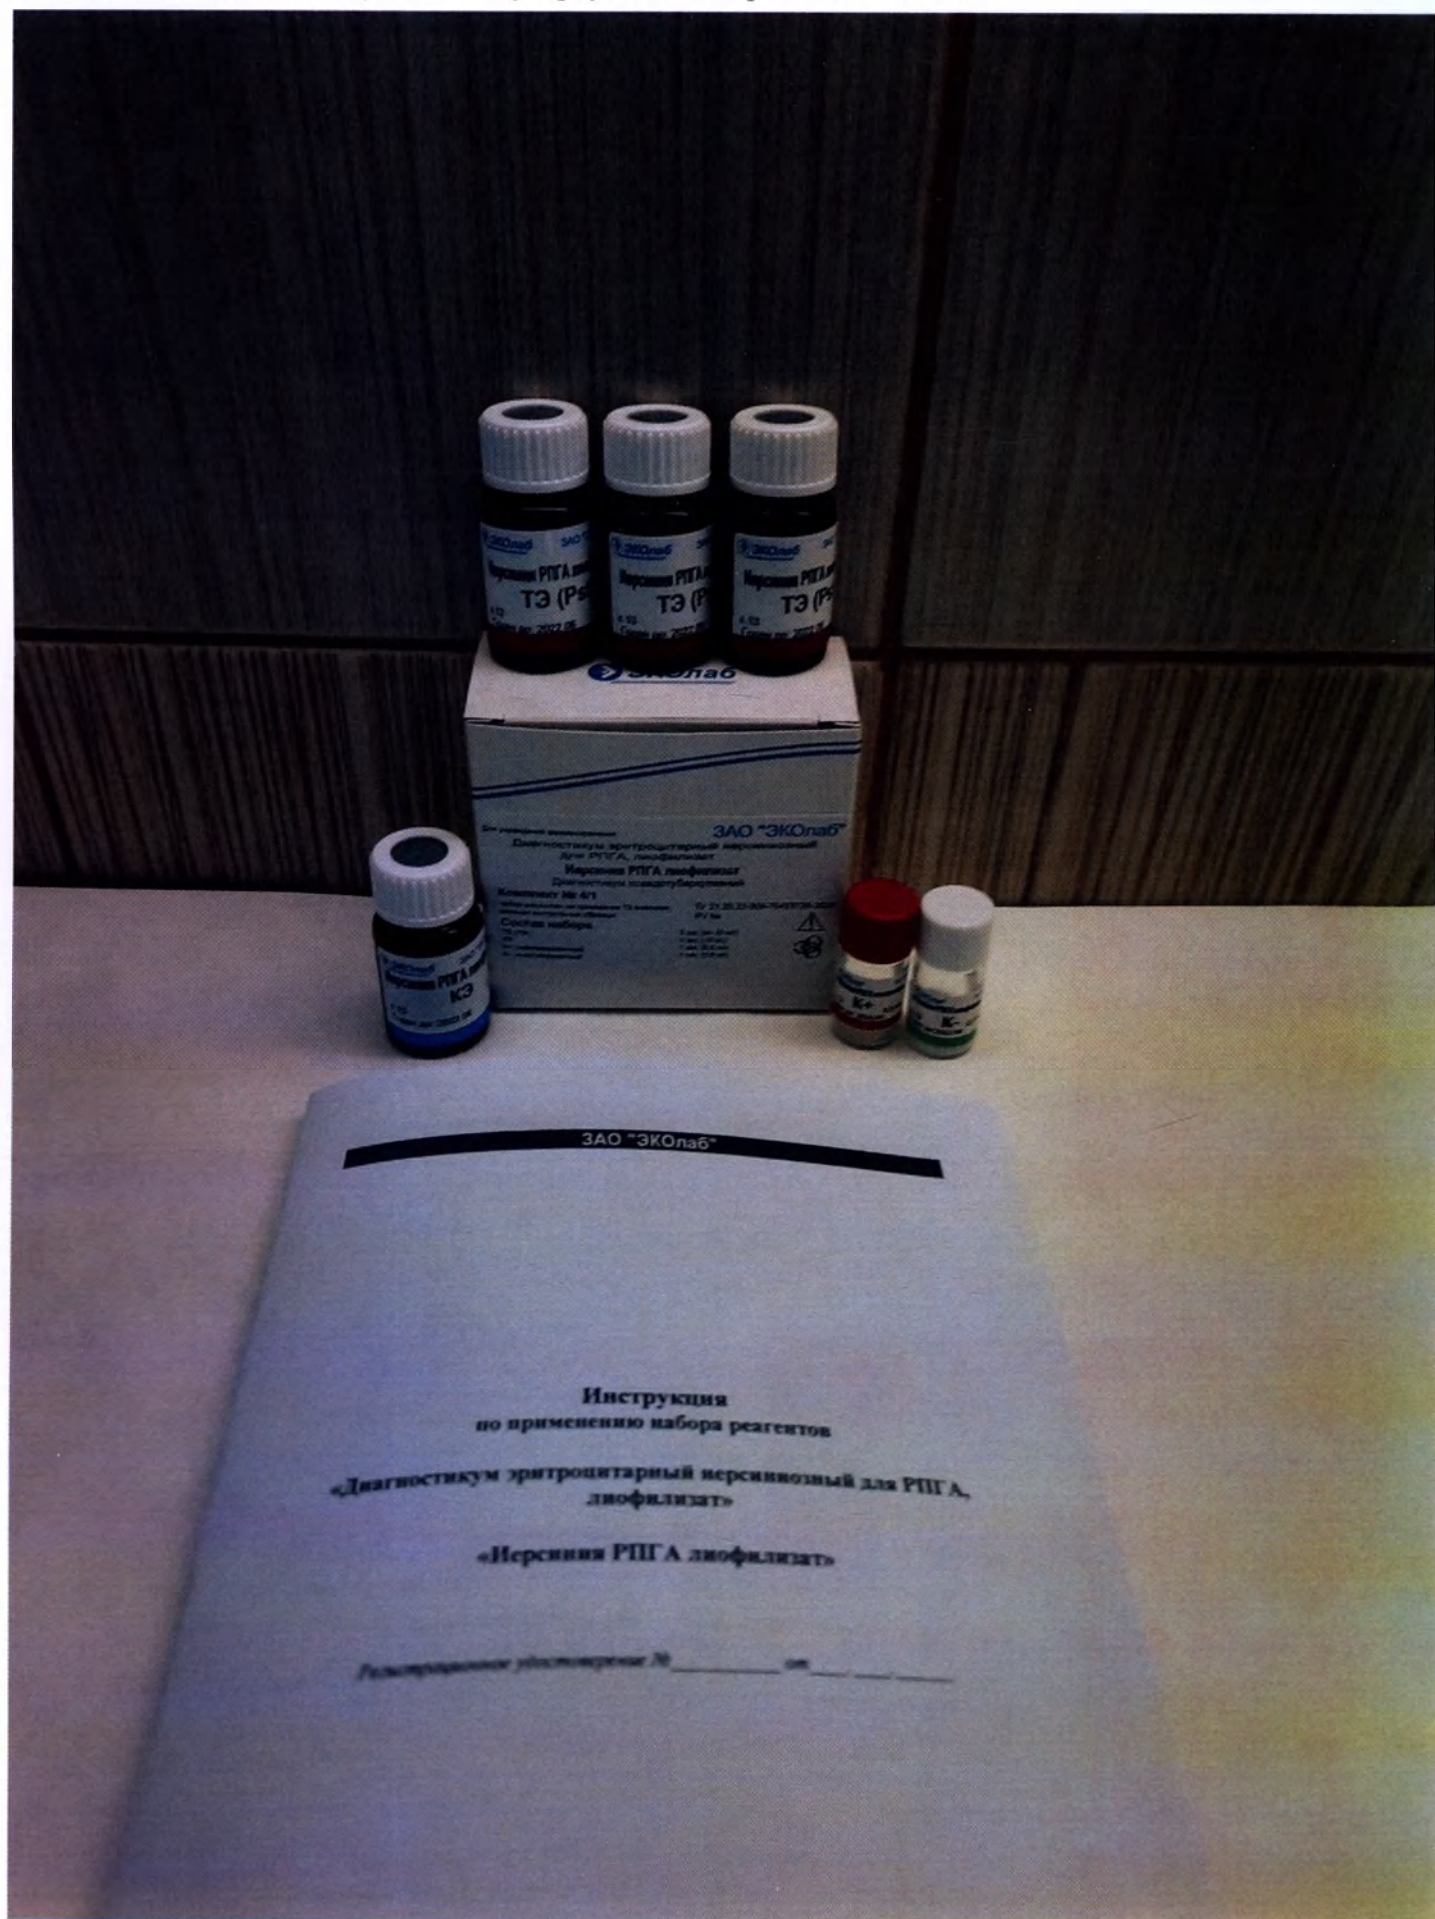

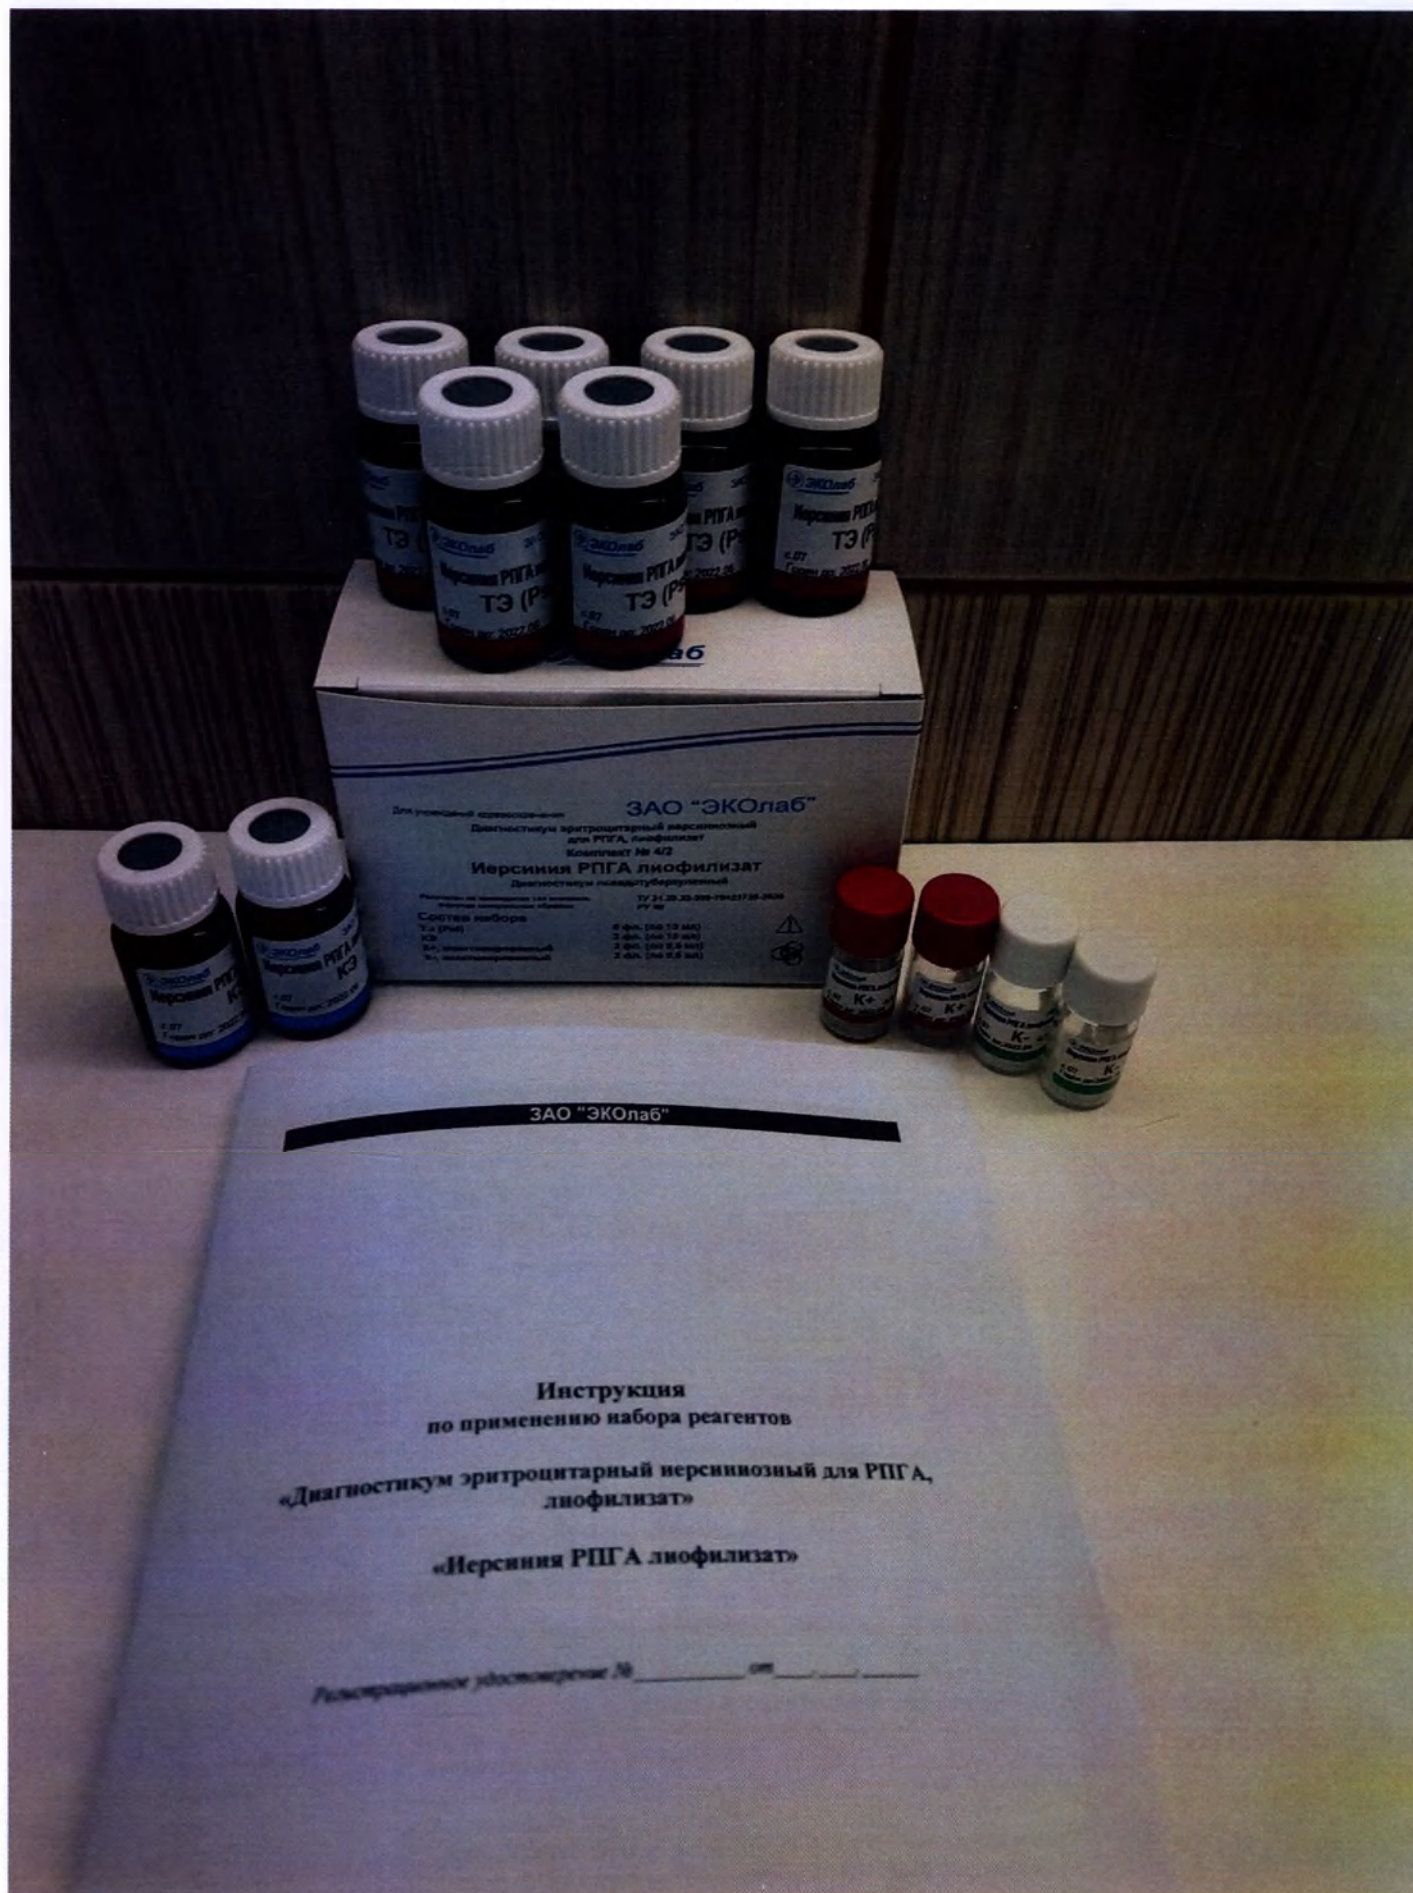

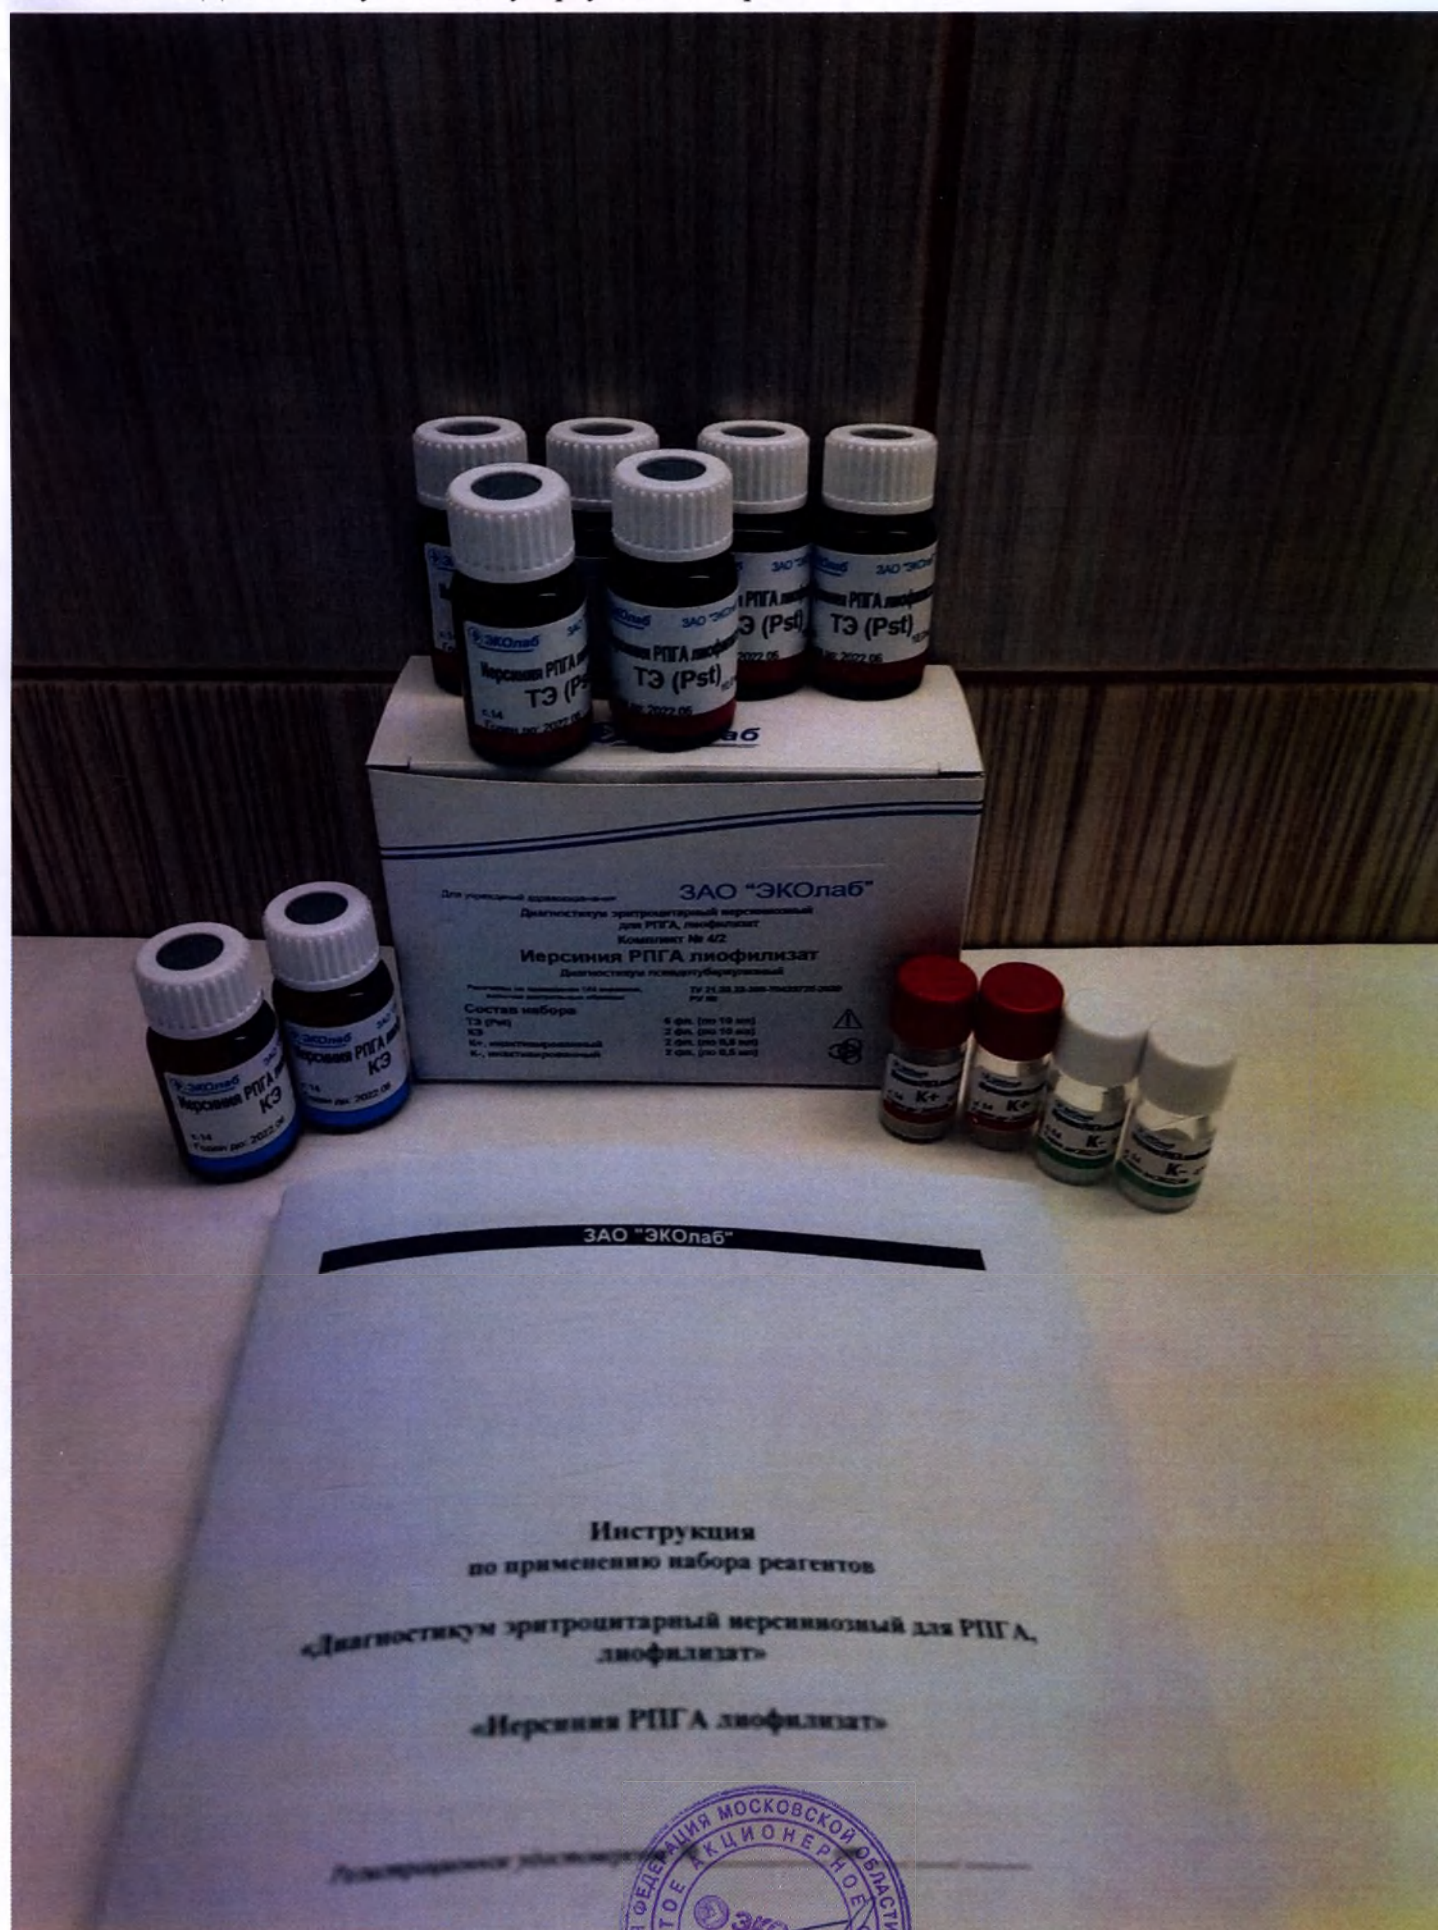

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 метр лист (16) лист
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.
"02" 08 2021 г.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 г.

Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»
Комплект: №1
Диагностикум иерсиниозный общий

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
ЗАО «ЭКОлаб»

Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат

Иерсиния РПГА лиофилизат

Диагностикум иерсиниозный общий

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение 72 анализов.


включая контрольные образцы

Состав набора

ТЭ (ОЗ)	1 фл. (по 10 мл)
ТЭ (ОФ)	1 фл. (по 10 мл)
ТЭ (Рст)	1 фл. (по 10 мл)
КЭ	1 фл. (10 мл)
К+, инaktivированный	1 фл. (0,5 мл)
К-, инaktivированный	1 фл. (0,5 мл)

ТУ 21.20.23-309-70423725-2020

Р/У №



ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

Иерсиния РПГА лиофилизат

Комплект №1

Каталожный №: 42.17

Серия: 01

Контрольный №: 1408

Дата изготовления: 2020.05.16

Годен до: 2022.06.16



ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»


Иерсиния РПГА лиофилизат

КЭ

с.01

Годен до: 2022.06

10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА лиофилизат

К+

с.01

Годен до: 2022.06

0,5 мл



ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА лиофилизат

К-

с.01

Годен до: 2022.06

0,5 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»
Комплект: № 2/1
Диагностикум кишечной иерсиниозный ОЗ

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
ЗАО "ЭКОлаб"
Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат
Иерсиния РПГА лиофилизат
Диагностикум кишечной иерсиниозный ОЗ
Комплект № 2/1
Набор рассчитан на проведение 72 анализов,
включая контрольные образцы
Состав набора
ТЗ (ОЗ)
КЭ
К+, инактивированный
К-, инактивированный
ТУ 21.20.23-309-70423725-2020
РУ №
3 фл. (по 10 мл)
1 фл. (10 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (0,5 мл)

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Иерсиния РПГА лиофилизат
ТЗ (ОЗ)
с.02 10,0 мл
Годен до: 2022.06

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Для профессионального применения
Иерсиния РПГА лиофилизат
Комплект № 2/1
Каталожный №: 42.18
Серия: 02
Контрольный №: 1409
Дата изготовления: 2020.05.16
Годен до: 2022.06.16

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Иерсиния РПГА лиофилизат
К+
с.02 0,5 мл
Годен до: 2022.06

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Иерсиния РПГА лиофилизат
КЭ
с.02 10,0 мл
Годен до: 2022.06

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Иерсиния РПГА лиофилизат
К-
с.02 0,5 мл
Годен до: 2022.06

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор

ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 г.

Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»
Комплект: № 2/2

Диагностикум кишечной иерсиниозный ОЗ

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат
Комплект № 2/2


Иерсиния РПГА лиофилизат
Диагностикум кишечной иерсиниозный ОЗ

Расчитан на проведение 144 анализов,
включая контрольные образцы

ТУ 21.20.23-309-70423725-2020
РУ №

Состав набора

ТЭ (ОЗ)	6 фл. (по 10 мл)
КЭ	2 фл. (по 10 мл)
К+, инактивированный	2 фл. (по 0,5 мл)
К-, инактивированный	2 фл. (по 0,5 мл)



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

Иерсиния РПГА лиофилизат

Комплект № 2/2

Каталожный №: 42.19

Серия: 03

Контрольный №: 1410

Дата изготовления: 2020.05.16

Годен до: 2022.06.16



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»


Иерсиния РПГА лиофилизат

ТЭ (ОЗ)

с.03

Годен до: 2022.06

10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»


Иерсиния РПГА лиофилизат

КЭ

с.03

Годен до: 2022.06

10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА лиофилизат

К+

с.03

Годен до: 2022.06

0,5 мл



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА лиофилизат

К-

с.03

Годен до: 2022.06

0,5 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»
Комплект: № 3/1
Диагностикум кишечной иерсиниозный О9

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат
Иерсиния РПГА лиофилизат
Диагностикум кишечной иерсиниозный О9

Комплект № 3/1
Набор рассчитан на проведение 72 анализов,
включая контрольные образцы

ТУ 21.20.23-309-70423725-2020
РУ №

Состав набора

ТЭ (О9)	3 фл. (по 10 мл)
КЭ	1 фл. (10 мл)
К+, инaktivированный	1 фл. (0,5 мл)
К-, инaktivированный	1 фл. (0,5 мл)

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
КЭ

с.04 10,0 мл
Годен до: 2022.06

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
К+

с.04 0,5 мл
Годен до: 2022.06

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
К-

с.04 0,5 мл
Годен до: 2022.06

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения
Иерсиния РПГА лиофилизат
Комплект № 3/1
Каталожный №: 42.20
Серия: 04
Контрольный №: 1411
Дата изготовления: 2020.05.16
Годен до: 2022.06.16

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
ТЭ (О9)

с.04 10,0 мл
Годен до: 2022.06

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
2020 г.

Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»

Комплект: № 3/2

Диагностикум кишечной иерсиниозный О9

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат
Комплект № 3/2


Иерсиния РПГА лиофилизат
Диагностикум кишечной иерсиниозный О9

Расчитан на проведение 144 анализов,
включая контрольные образцы

ТУ 21.20.23-309-70423725-2020
РУ №

Состав набора

ТЭ (О9)	6 фл. (по 10 мл)
КЭ	2 фл. (по 10 мл)
К+, инактивированный	2 фл. (по 0,5 мл)
К-, инактивированный	2 фл. (по 0,5 мл)



ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

Иерсиния РПГА лиофилизат

Комплект № 3/2

Каталожный №: 42.21

Серия: 05

Контрольный №: 1412

Дата изготовления: 2020.05.16

Годен до: 2022.06.16



ЗАО «ЭКОлаб»


Иерсиния РПГА лиофилизат

ТЭ (О9)

с.05

Годен до: 2022.06

10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб»


Иерсиния РПГА лиофилизат

КЭ

с.05

Годен до: 2022.06

10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА лиофилизат

К+

с.05

Годен до: 2022.06

0,5 мл



ЗАО «ЭКОлаб»

Иерсиния РПГА лиофилизат

К-

с.05

Годен до: 2022.06

0,5 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов
2020 г.

Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»
Комплект: № 4/1
Диагностикум псевдотуберкулезный

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат
Иерсиния РПГА лиофилизат
Диагностикум псевдотуберкулезный


Комплект № 4/1

Набор рассчитан на проведение 72 анализов,
включая контрольные образцы

ТУ 21.20.23-309-70423725-2020
РУ №

Состав набора

ТЗ (Pst)	3 фл. (по 10 мл)
КЭ	1 фл. (10 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,5 мл)



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения
Иерсиния РПГА лиофилизат
Комплект № 4/1
Каталожный №: 42.22
Серия: 06
Контрольный №: 1413
Дата изготовления: 2020.05.16
Годен до: 2022.06.16



ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
ТЗ (Pst)


с.06
Годен до: 2022.06
10,0 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
КЭ


с.06
Годен до: 2022.06
10,0 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
К+


с.06
Годен до: 2022.06
0,5 мл



ЗАО "ЭКОлаб"

Иерсиния РПГА лиофилизат
К-

с.06
Годен до: 2022.06
0,5 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



Комплект этикеток
«Иерсиния РПГА лиофилизат»
Комплект: № 4/2
Диагностикум псевдотуберкулезный

Набор реактивов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный
для РПГА, лиофилизат
Комплект № 4/2


Иерсиния РПГА лиофилизат
Диагностикум псевдотуберкулезный

Расчитан на проведение 144 анализов,
включая контрольные образцы


ТУ 21.20.23-309-70423725-2020
РУ №

Состав набора

ТЭ (Pst)	6 фл. (по 10 мл)
КЭ	2 фл. (по 10 мл)
К+, инактивированный	2 фл. (по 0,5 мл)
К-, инактивированный	2 фл. (по 0,5 мл)




ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
Для профессионального применения
Иерсиния РПГА лиофилизат
Комплект № 4/2
Каталожный №: 42.23
Серия: 07
Контрольный №: 1414
Дата изготовления: 2020.05.16
Годен до: 2022.06.16



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
Иерсиния РПГА лиофилизат
ТЭ (Pst)
с.07
Годен до: 2022.06
10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
Иерсиния РПГА лиофилизат
КЭ
с.07
Годен до: 2022.06
10,0 мл



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
Иерсиния РПГА лиофилизат
К+
с.07
Годен до: 2022.06
0,5 мл



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
Иерсиния РПГА лиофилизат
К-
с.07
Годен до: 2022.06
0,5 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (семь) лист 06
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"02" 04 2021 г.

