


ЗАО «ЭКОлаб» 142530 Московская обл., г.Электрогорск, ул.Буденного, д.1

e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru

Тел: 8-800-333-33-47

ИНН: 5035025076, КПП: 503501001

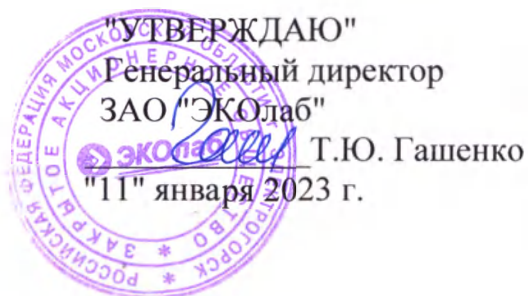



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO-ДИАГНОСТИКИ**

**Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий
типа Лейшмана (в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Фотографические изображения общего вида
Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий типа Лейшмана
(в растворе)
(«ЭКОлаб-Лейшман»)

Комплект № 1 серия 01/23 от 2023.01.10

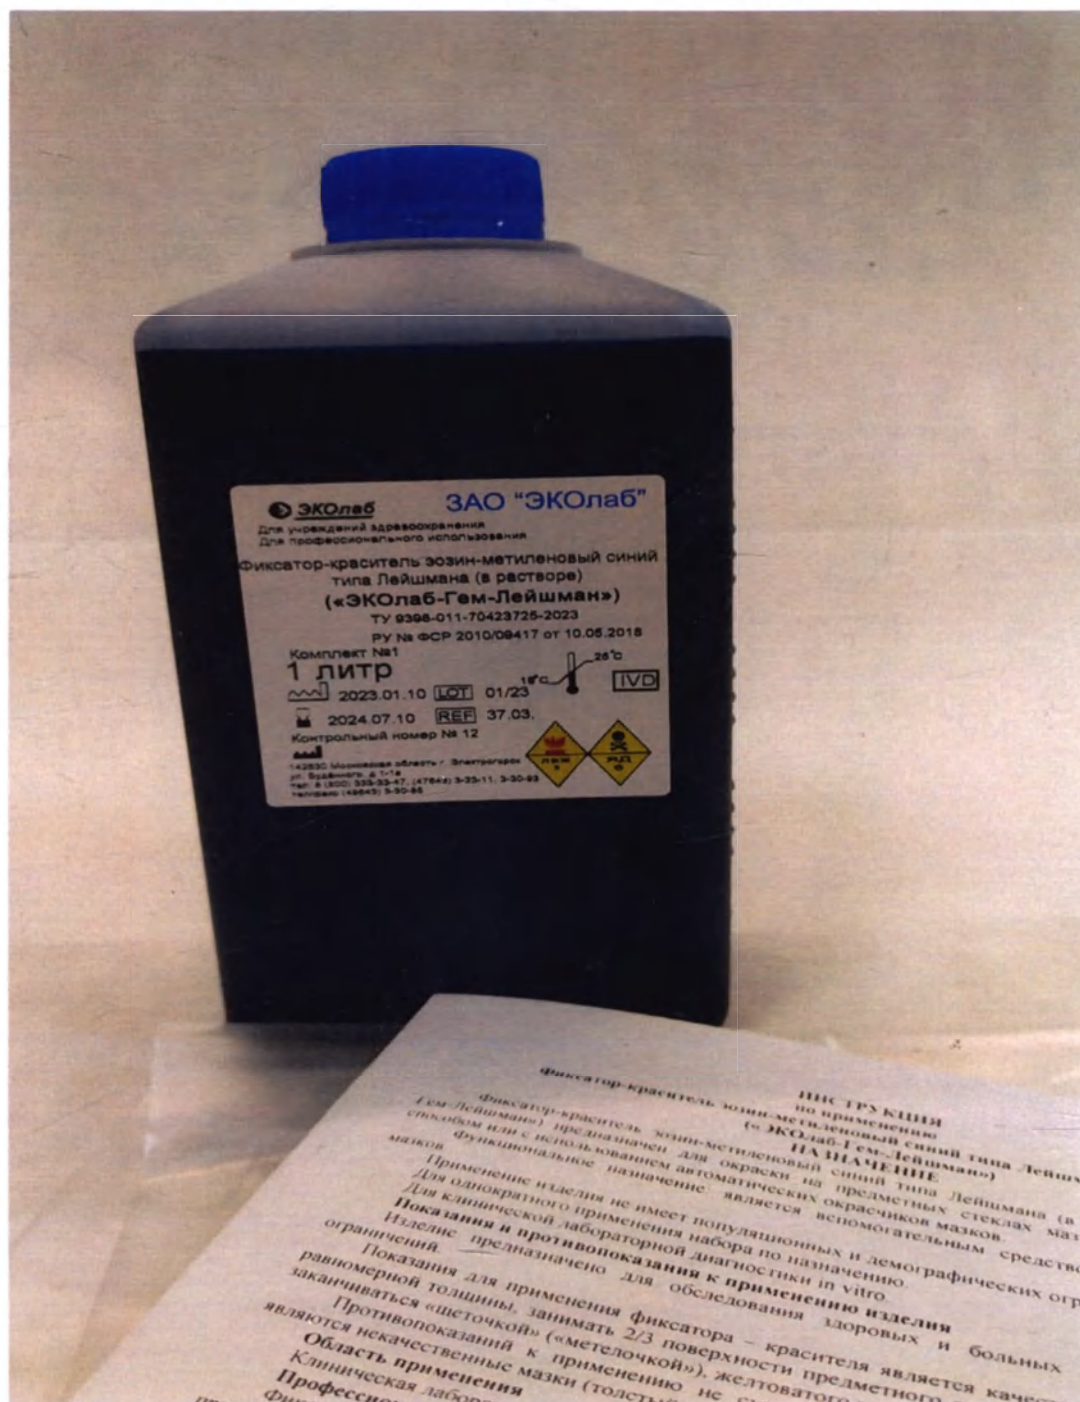

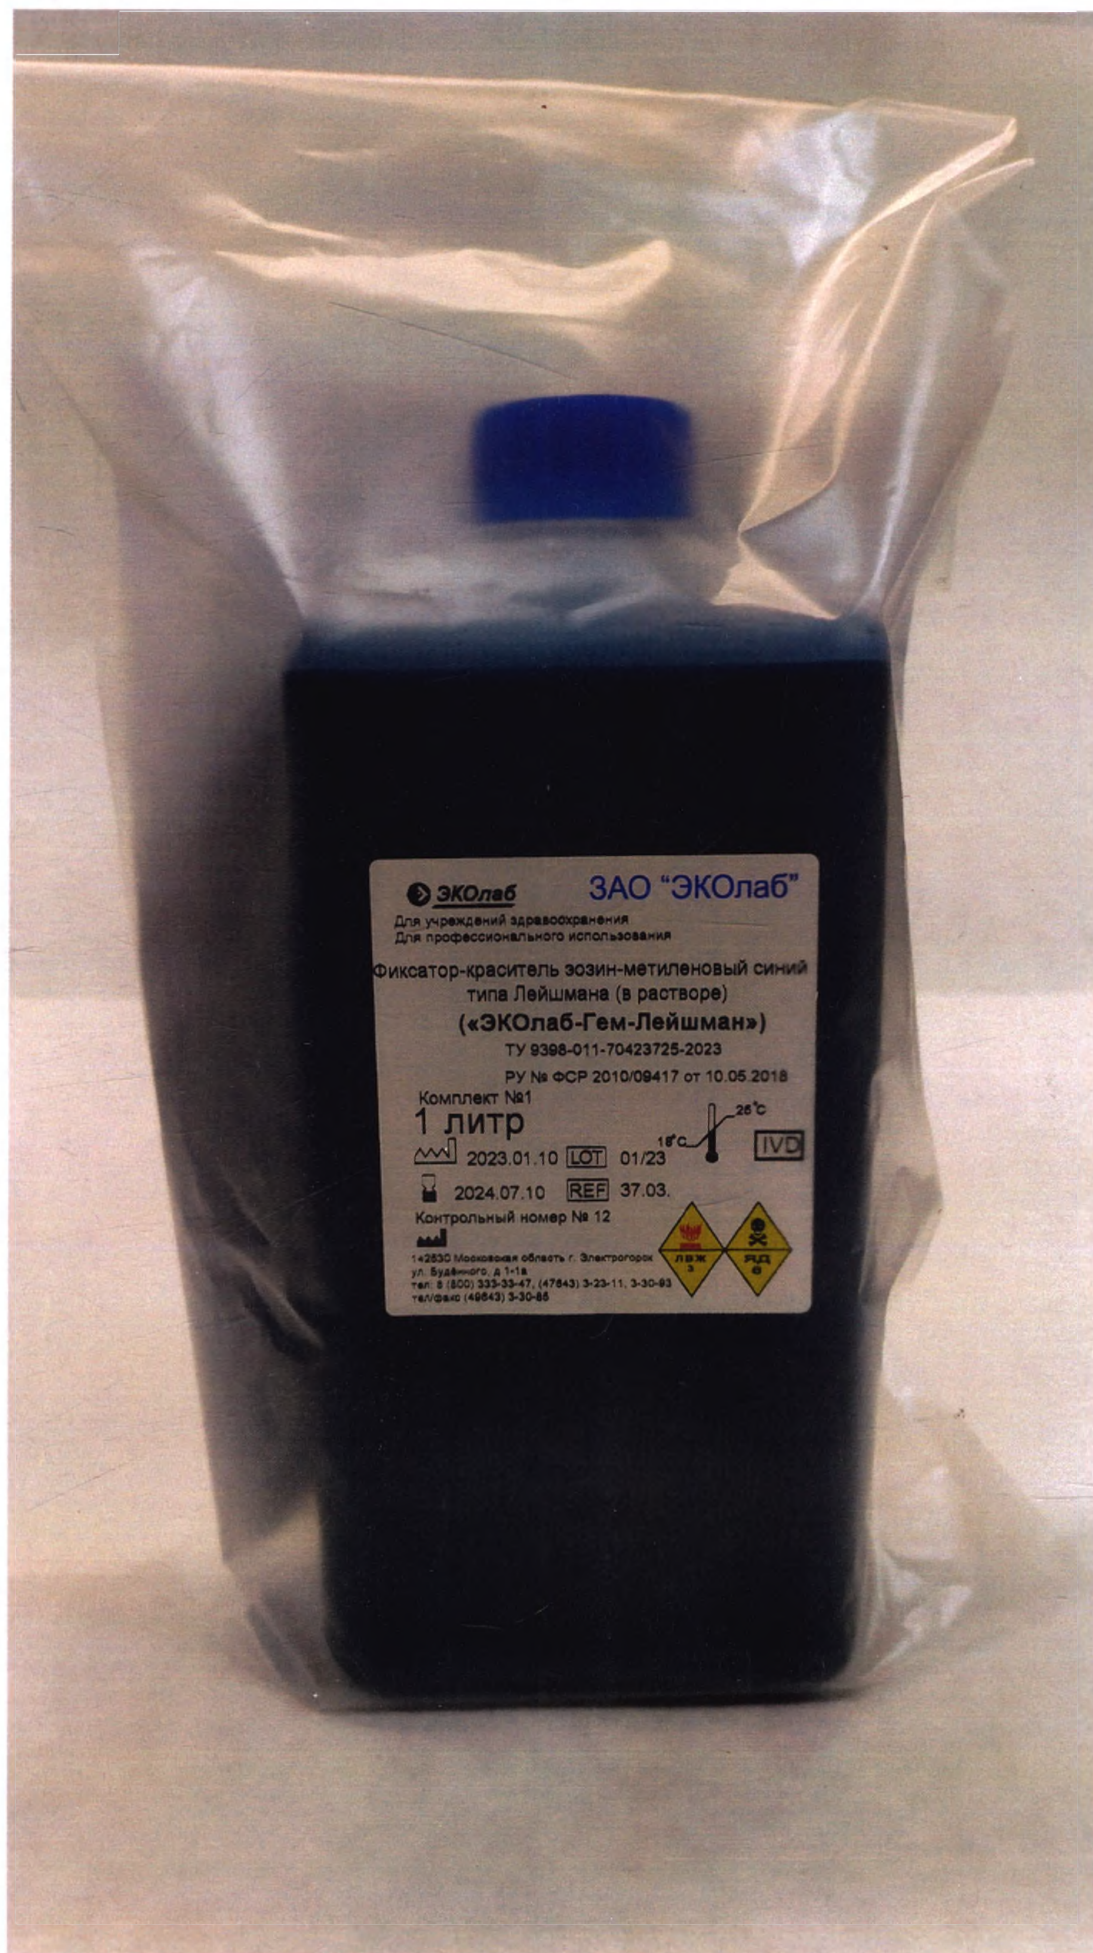

ЭКОлаб **ЗАО "ЭКОлаб"**
Для учреждений здравоохранения
Для профессионального использования

Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий
типа Лейшмана (в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
ТУ 9398-011-70423725-2023
РУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект №1
1 литр

 2023.01.10 **LOT** 01/23  


 2024.07.10 **REF** 37.03.

Контрольный номер №12

142830 Московская область г. Электрогорск
ул. Буденного, д. 1-1а
тел. 8 (800) 333-33-47, (47843) 3-23-11, 3-30-93
тел/факс (47843) 3-30-85

Комплект №1 серия 03/23 от 2023.01.11

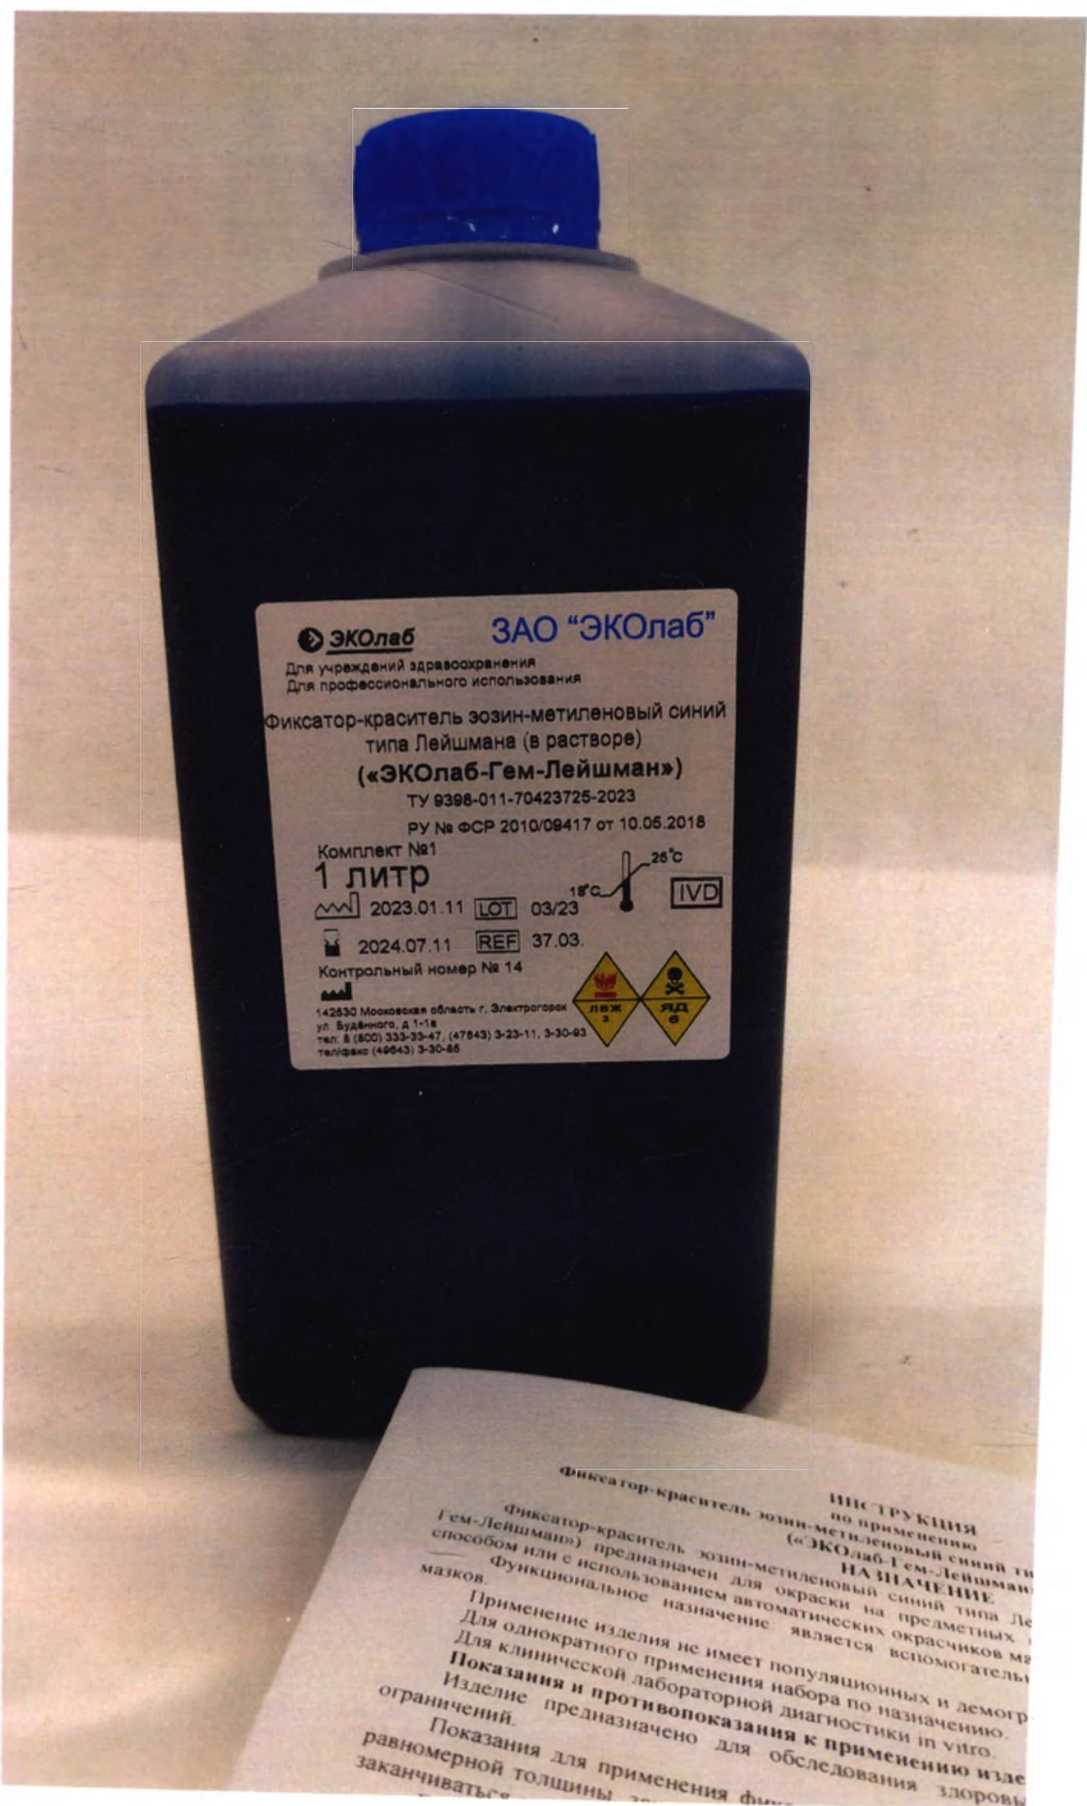

ЭКОлаб **ЗАО "ЭКОлаб"**
Для учреждений здравоохранения
Для профессионального использования

Фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий
типа Лейшмана (в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
ТУ 9398-011-70423726-2023
ПУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект №1
1 литр

2023.01.11 LOT 03/23 18°C 26°C IVD
2024.07.11 REF 37.03.

Контрольный номер № 14

142630 Московская область г. Электрогорск
ул. Будённого, д. 1-1/8
тел: 8 (800) 333-33-47, (47843) 3-23-11, 3-30-63
телефакс (49843) 3-30-66

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий
типа Лейшмана («ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
НАЗНАЧЕНИЕ
Фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий типа Лейшмана («ЭКОлаб-Гем-Лейшман») предназначен для окраски на предметных стеклах мазков, полученных с использованием автоматических окрасочных машин. Функциональное назначение: является вспомогательным средством.

Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Показания и противопоказания к применению изделия

Изделие предназначено для обследования здоровых и больных людей.

Показания для применения фиксатора-красителя зозин-метиленовый синий типа Лейшмана («ЭКОлаб-Гем-Лейшман») — для окраски мазков, полученных с использованием автоматических окрасочных машин.

Противопоказания для применения фиксатора-красителя зозин-метиленовый синий типа Лейшмана («ЭКОлаб-Гем-Лейшман») — для окраски мазков, полученных с использованием автоматических окрасочных машин.



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального использования

Фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий
типа Лейшмана (в растворе)

(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)


ТУ 9398-011-70423725-2023

ПУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект №1

1 литр

2023.01.11 LOT 03/23



IVD


2024.07.11 REF 37.03.

Контрольный номер № 14

142830 Московская область г. Электрогорск
ул. Буденного, д. 1-1а
тел: 8 (800) 333-33-47, (47643) 3-23-11, 3-30-93
факс: (47643) 3-30-88





Комплект № 2 серия 02/23 от 2023.01.10

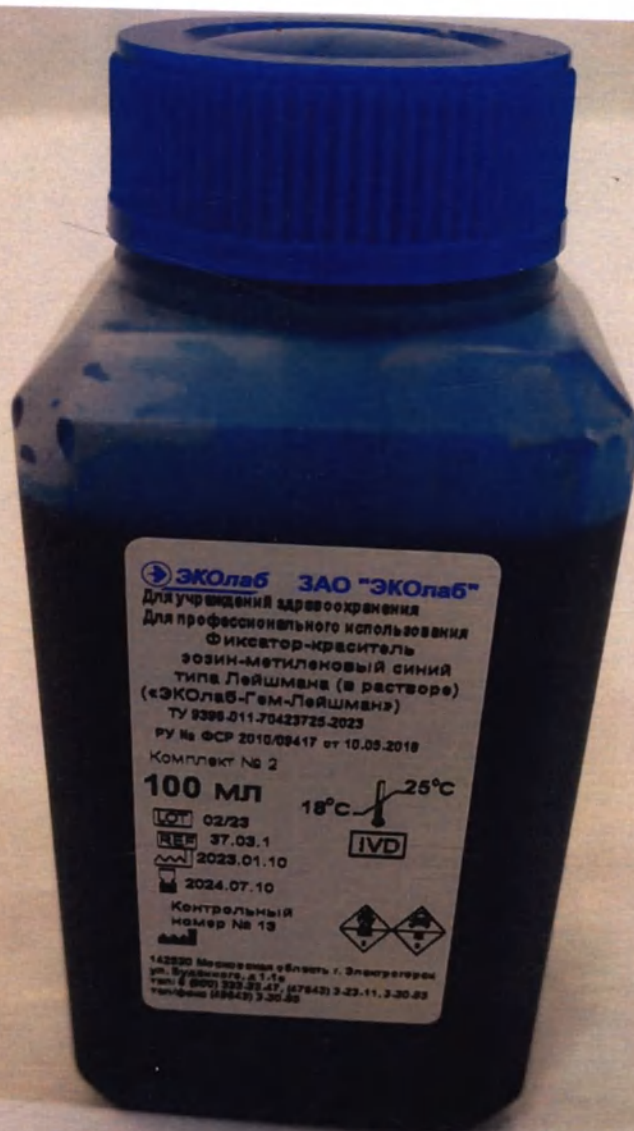

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий типа Лейшмана (в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
НАЗНАЧЕНИЕ
Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий типа Лейшмана (в растворе) («ЭКОлаб-Гем-Лейшман») предназначен для окраски на предметных стеклах мазков крови с использованием автоматических окрасчиков мазков.
Назначение: является вспомогательным средством для микроскопического исследования.
Использование набора по назначению.
Использование набора для лабораторной диагностики in vitro.
Вопреказания к применению изделия

Комплект № 2 серия 04/23 от 2023.01.11

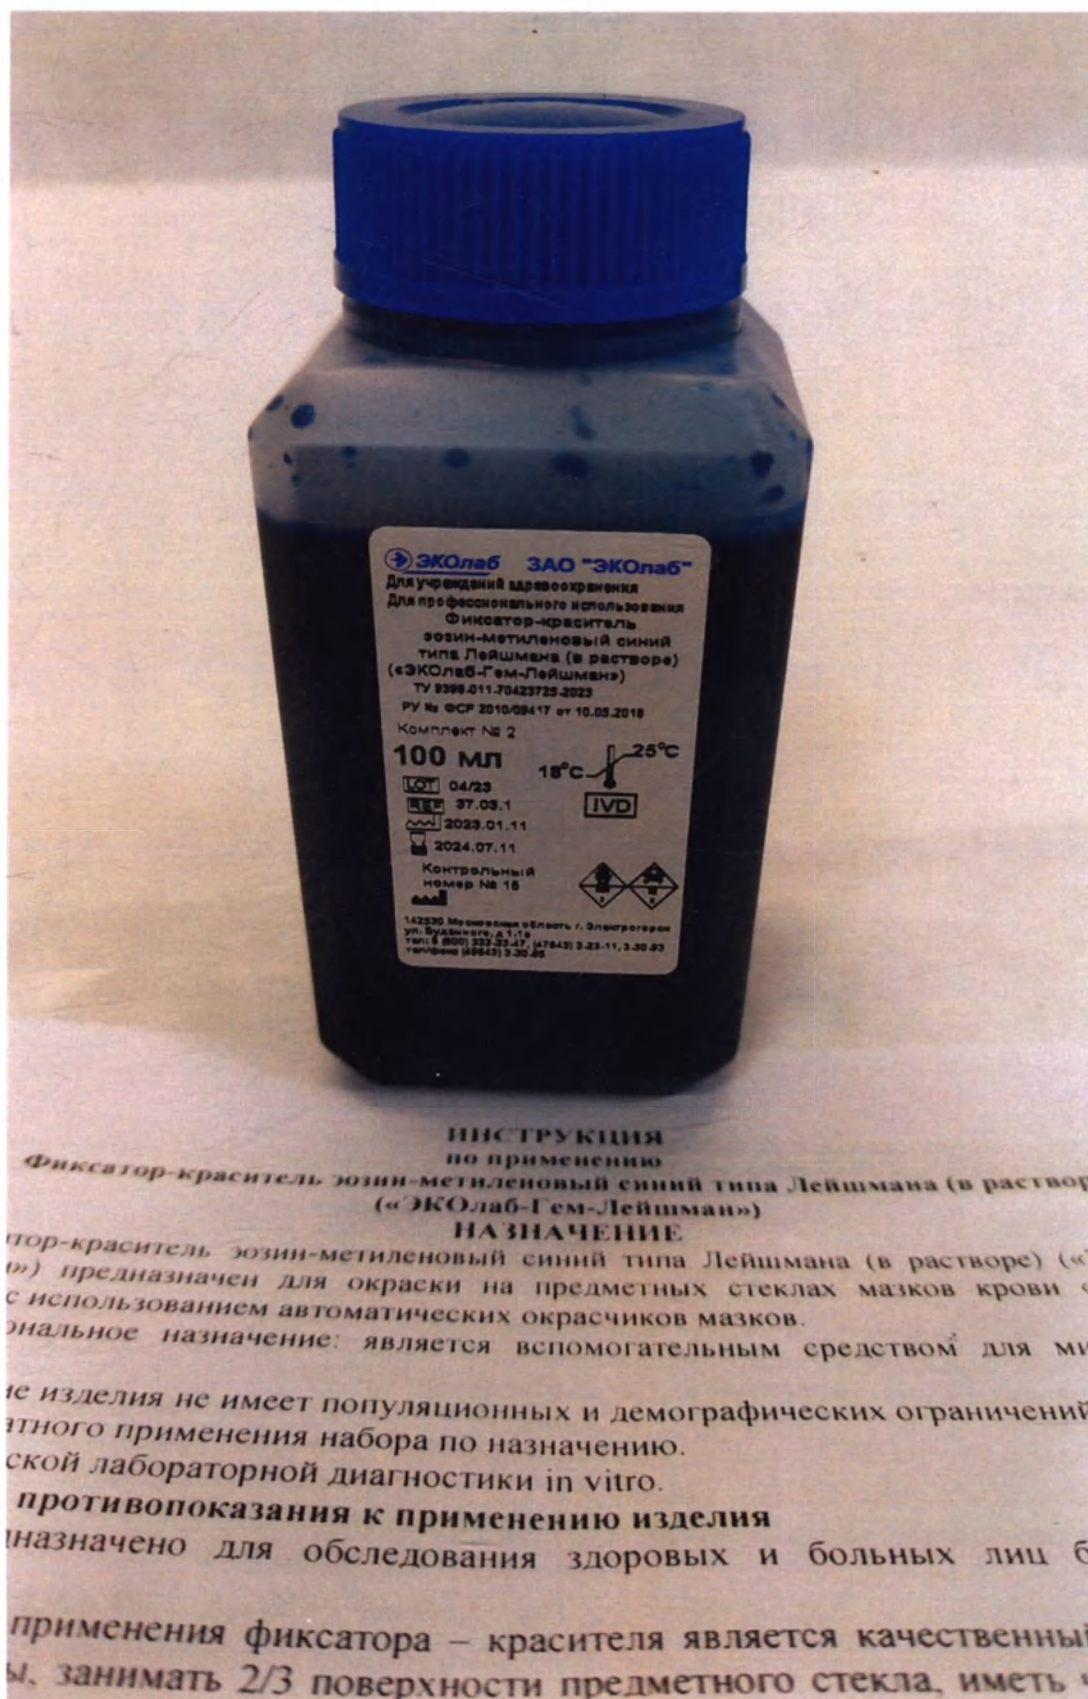

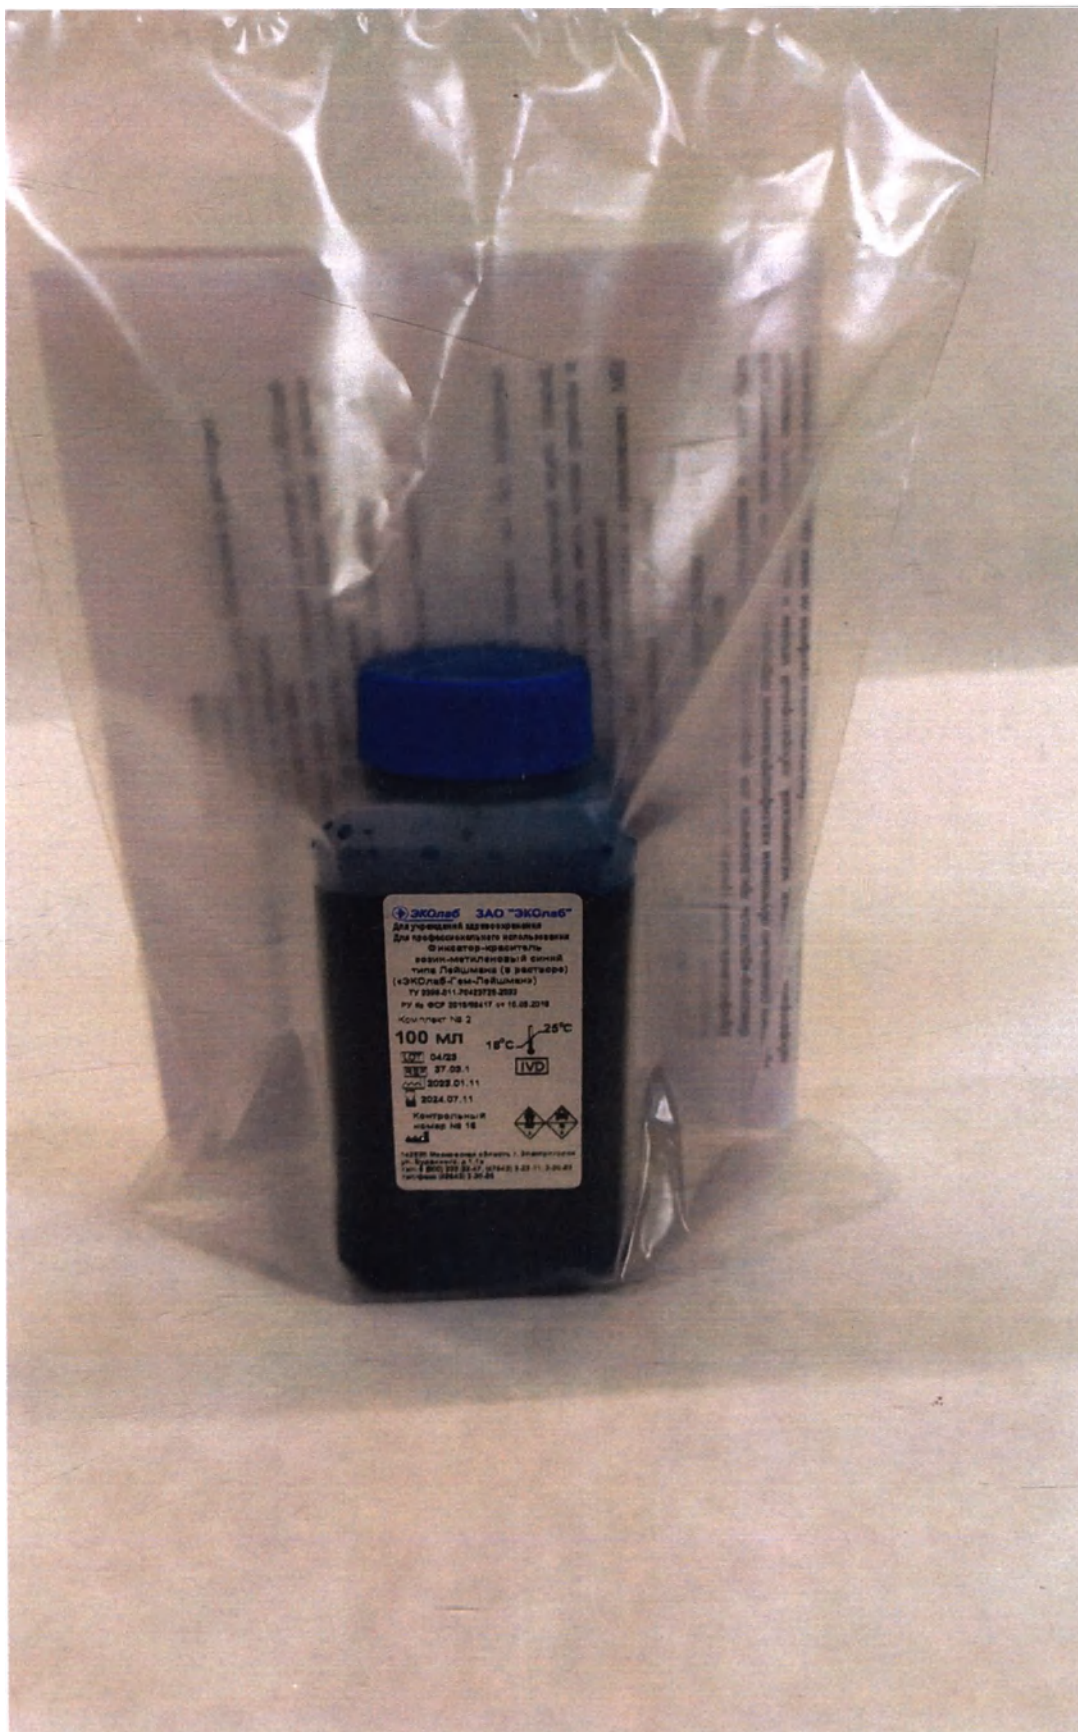

Начальник НПО «Биохимия»

Г.В. Филатова

СОГЛАСОВАНО

Директор по качеству ЗАО «ЭКОлаб»

Т.В. Юрина



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю

"20" 06 2023 г.




ЗАО «ЭКОлаб» 142530 Московская обл., г.Электрoгoрск, ул.Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru
Тел: 8-800-333-33-47
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

 Т.Ю. Гашенко
"11" января 2023 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO-ДИАГНОСТИКИ

**Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий
типа Лейшмана (в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий типа Лейшмана (в растворе) («ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)

Комплект № 1 серия 01/23

Комплект № 2 серия 02/23

ЭКОлаб **ЗАО «ЭКОлаб»**
 Для учреждений здравоохранения
 Для профессионального использования

Фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий
 типа Лейшмана (в растворе)
 («ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
 ТУ 9398-011-70423725-2023
 РУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект №1
1 литр

2023.01.10 LOT 01/23 IVD
 2024.07.10 REF 37.03.
 Контрольный номер № 12

142530 Московская область г. Электрогорск
 ул. Буденного, д. 1-1а
 тел: 8 (800) 333-33-47, (47843) 3-23-11, 3-30-83
 тел/факс (49843) 3-30-85

ЭКОлаб **ЗАО «ЭКОлаб»**
 Для учреждений здравоохранения
 Для профессионального использования

Фиксатор-краситель
 зозин-метиленовый синий
 типа Лейшмана (в растворе)
 («ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
 ТУ 9398-011-70423725-2023
 РУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект № 2
100 мл

2023.01.10 IVD
 2024.07.10
 Контрольный
 номер № 13

142530 Московская область г. Электрогорск
 ул. Буденного, д. 1-1а
 тел: 8 (800) 333-33-47, (47843) 3-23-11, 3-30-83
 тел/факс (49843) 3-30-85

Комплект № 1 серия 03/23

Комплект № 2 серия 04/23

ЭКОлаб **ЗАО «ЭКОлаб»**
 Для учреждений здравоохранения
 Для профессионального использования

Фиксатор-краситель зозин-метиленовый синий
 типа Лейшмана (в растворе)
 («ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
 ТУ 9398-011-70423725-2023
 РУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект №1
1 литр

2023.01.11 LOT 03/23 IVD
 2024.07.11 REF 37.03.
 Контрольный номер № 14

142530 Московская область г. Электрогорск
 ул. Буденного, д. 1-1а
 тел: 8 (800) 333-33-47, (47843) 3-23-11, 3-30-83
 тел/факс (49843) 3-30-85

ЭКОлаб **ЗАО «ЭКОлаб»**
 Для учреждений здравоохранения
 Для профессионального использования

Фиксатор-краситель
 зозин-метиленовый синий
 типа Лейшмана (в растворе)
 («ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)
 ТУ 9398-011-70423725-2023
 РУ № ФСР 2010/09417 от 10.05.2018

Комплект № 2
100 мл

2023.01.11 IVD
 2024.07.11
 Контрольный
 номер № 15

142530 Московская область г. Электрогорск
 ул. Буденного, д. 1-1а
 тел: 8 (800) 333-33-47, (47843) 3-23-11, 3-30-83
 тел/факс (49843) 3-30-85

Начальник НПО «Биохимия»

СОГЛАСОВАНО

Директор по качеству ЗАО «ЭКОлаб»

Г.В. Филатова

Т.В. Юрина




**Фиксатор-краситель эозин-метиленовый синий типа Лейшмана
(в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Транспортная тара

Комплект № 1 серия 01/23

Комплект № 2 серия 02/23



ЗАО "ЭКОлаб"

**Фиксатор-краситель
эозин-метиленовый синий типа Лейшмана
(в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Хранить при температуре (18-25)°C
Транспортировать при температуре (5-30)°C

Количество наборов:

Комплект №1

Масса нетто:


LOT 01/23

Масса брутто:

Масса потребительской
упаковки:

2024.07.10

Комплект № 1 серия 03/23



ЗАО "ЭКОлаб"

**Фиксатор-краситель
эозин-метиленовый синий типа Лейшмана
(в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Хранить при температуре (18-25)°C
Транспортировать при температуре (5-30)°C

Количество наборов:

Комплект №1

Масса нетто:

LOT 03/23


Масса брутто:

Масса потребительской
упаковки:

2024.07.11

Начальник НПО «Биохимия»
СОГЛАСОВАНО

Директор по качеству ЗАО «ЭКОлаб»



ЗАО "ЭКОлаб"

**Фиксатор-краситель
эозин-метиленовый синий типа Лейшмана
(в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Хранить при температуре (18-25)°C
Транспортировать при температуре (5-30)°C

Количество наборов:

Комплект №2

Масса нетто:


LOT 02/23

Масса брутто:

Масса потребительской
упаковки:

2024.07.10

Комплект № 2 серия 04/23



ЗАО "ЭКОлаб"

**Фиксатор-краситель
эозин-метиленовый синий типа Лейшмана
(в растворе)
(«ЭКОлаб-Гем-Лейшман»)**

Хранить при температуре (18-25)°C
Транспортировать при температуре (5-30)°C

Количество наборов:

Комплект №2

Масса нетто:

LOT 04/23

Масса брутто:

Масса потребительской
упаковки:

2024.07.11

Г.В. Филатова

Т.В. Юрина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 лист

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

10.06 2023 г.

