

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»

Н.Н. Перцева


«26» августа 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Разбавитель образцов (Diluent Universal) для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка
250 мл*4 шт

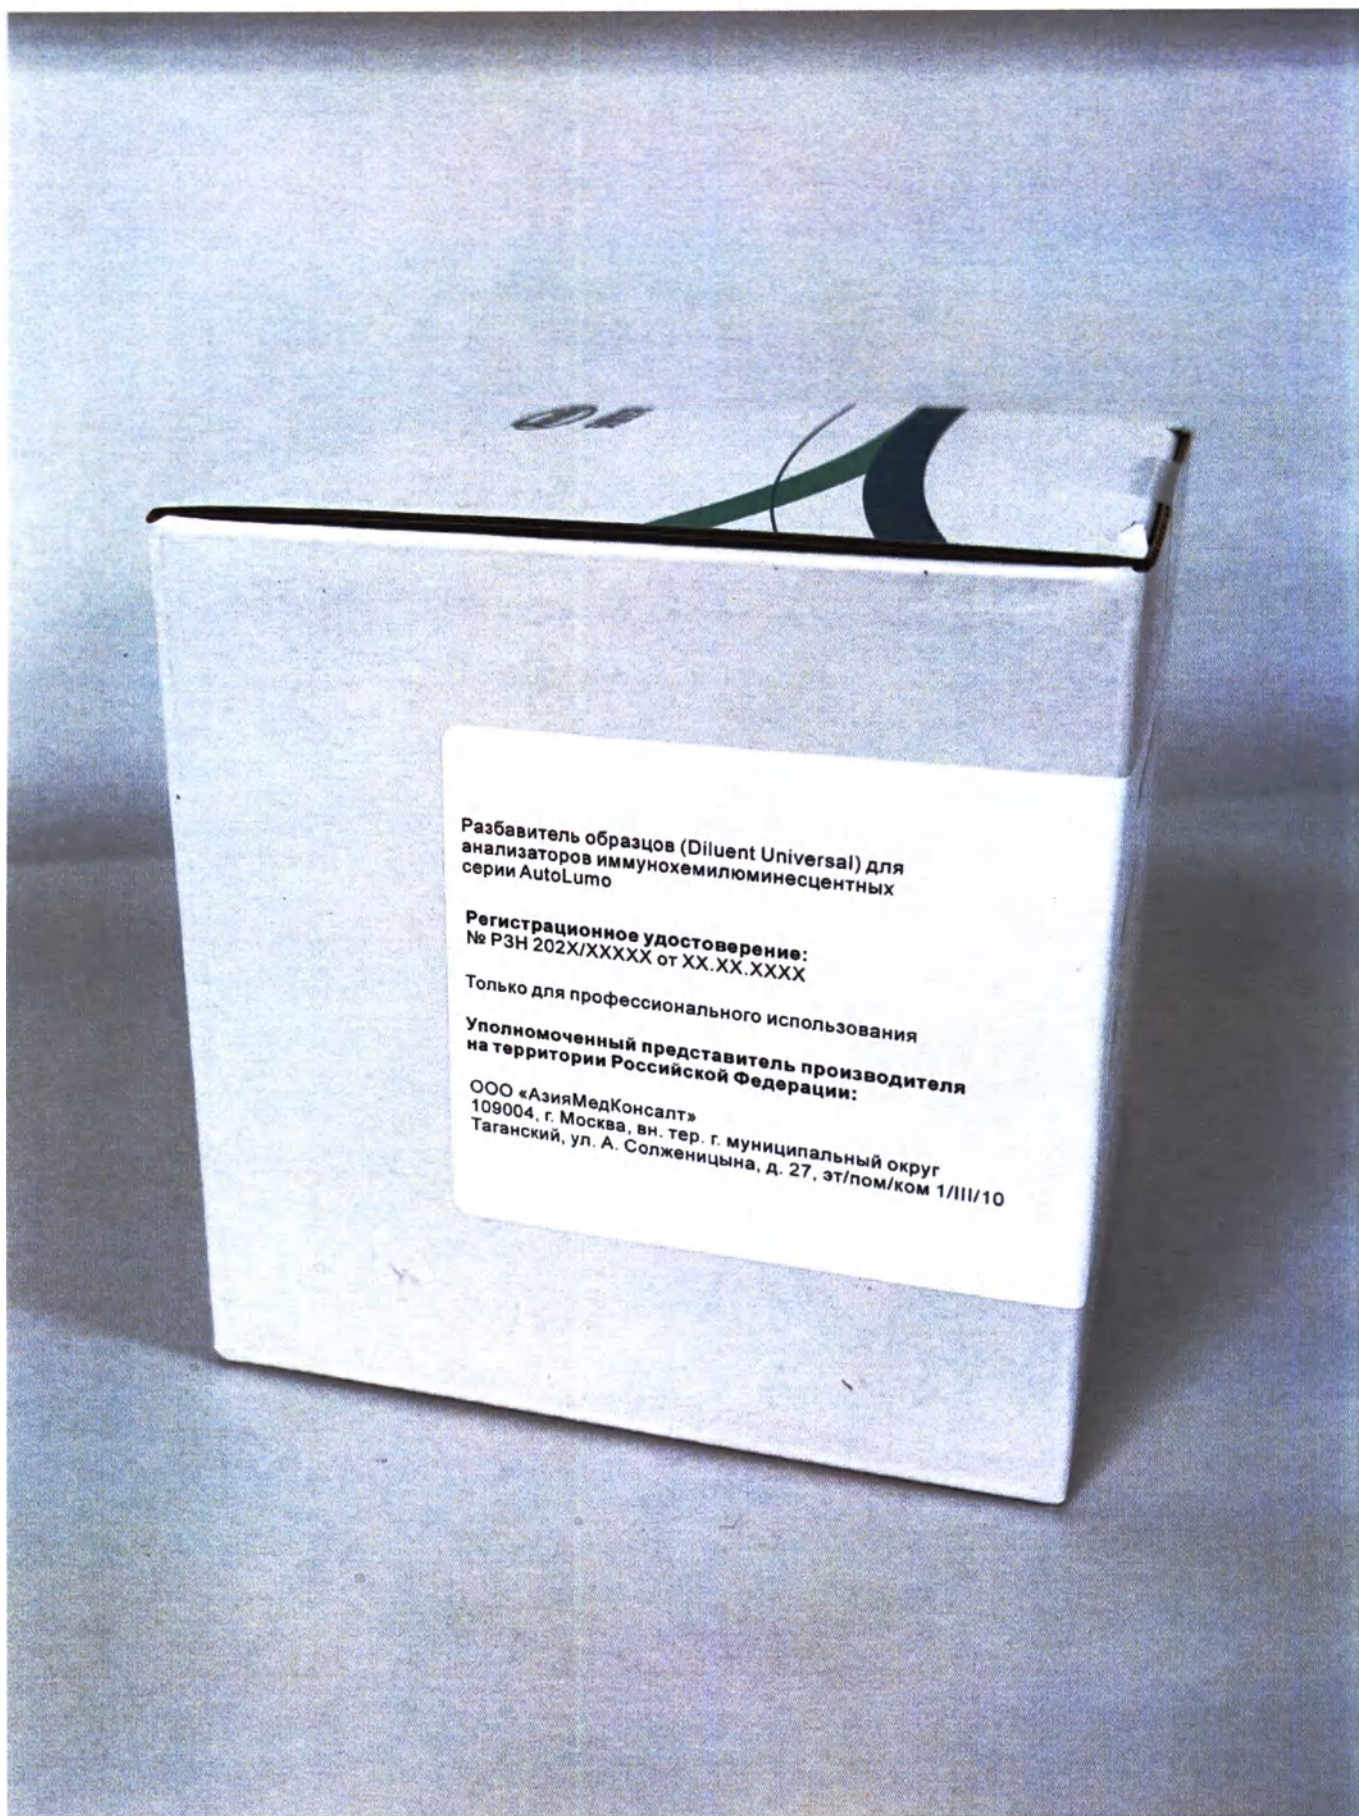

Разбавитель образцов (Diluent Universal) для
анализаторов иммунохемилюминесцентных
серии AutoLumo

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования


Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 250 мл*4 шт



Фото флакона

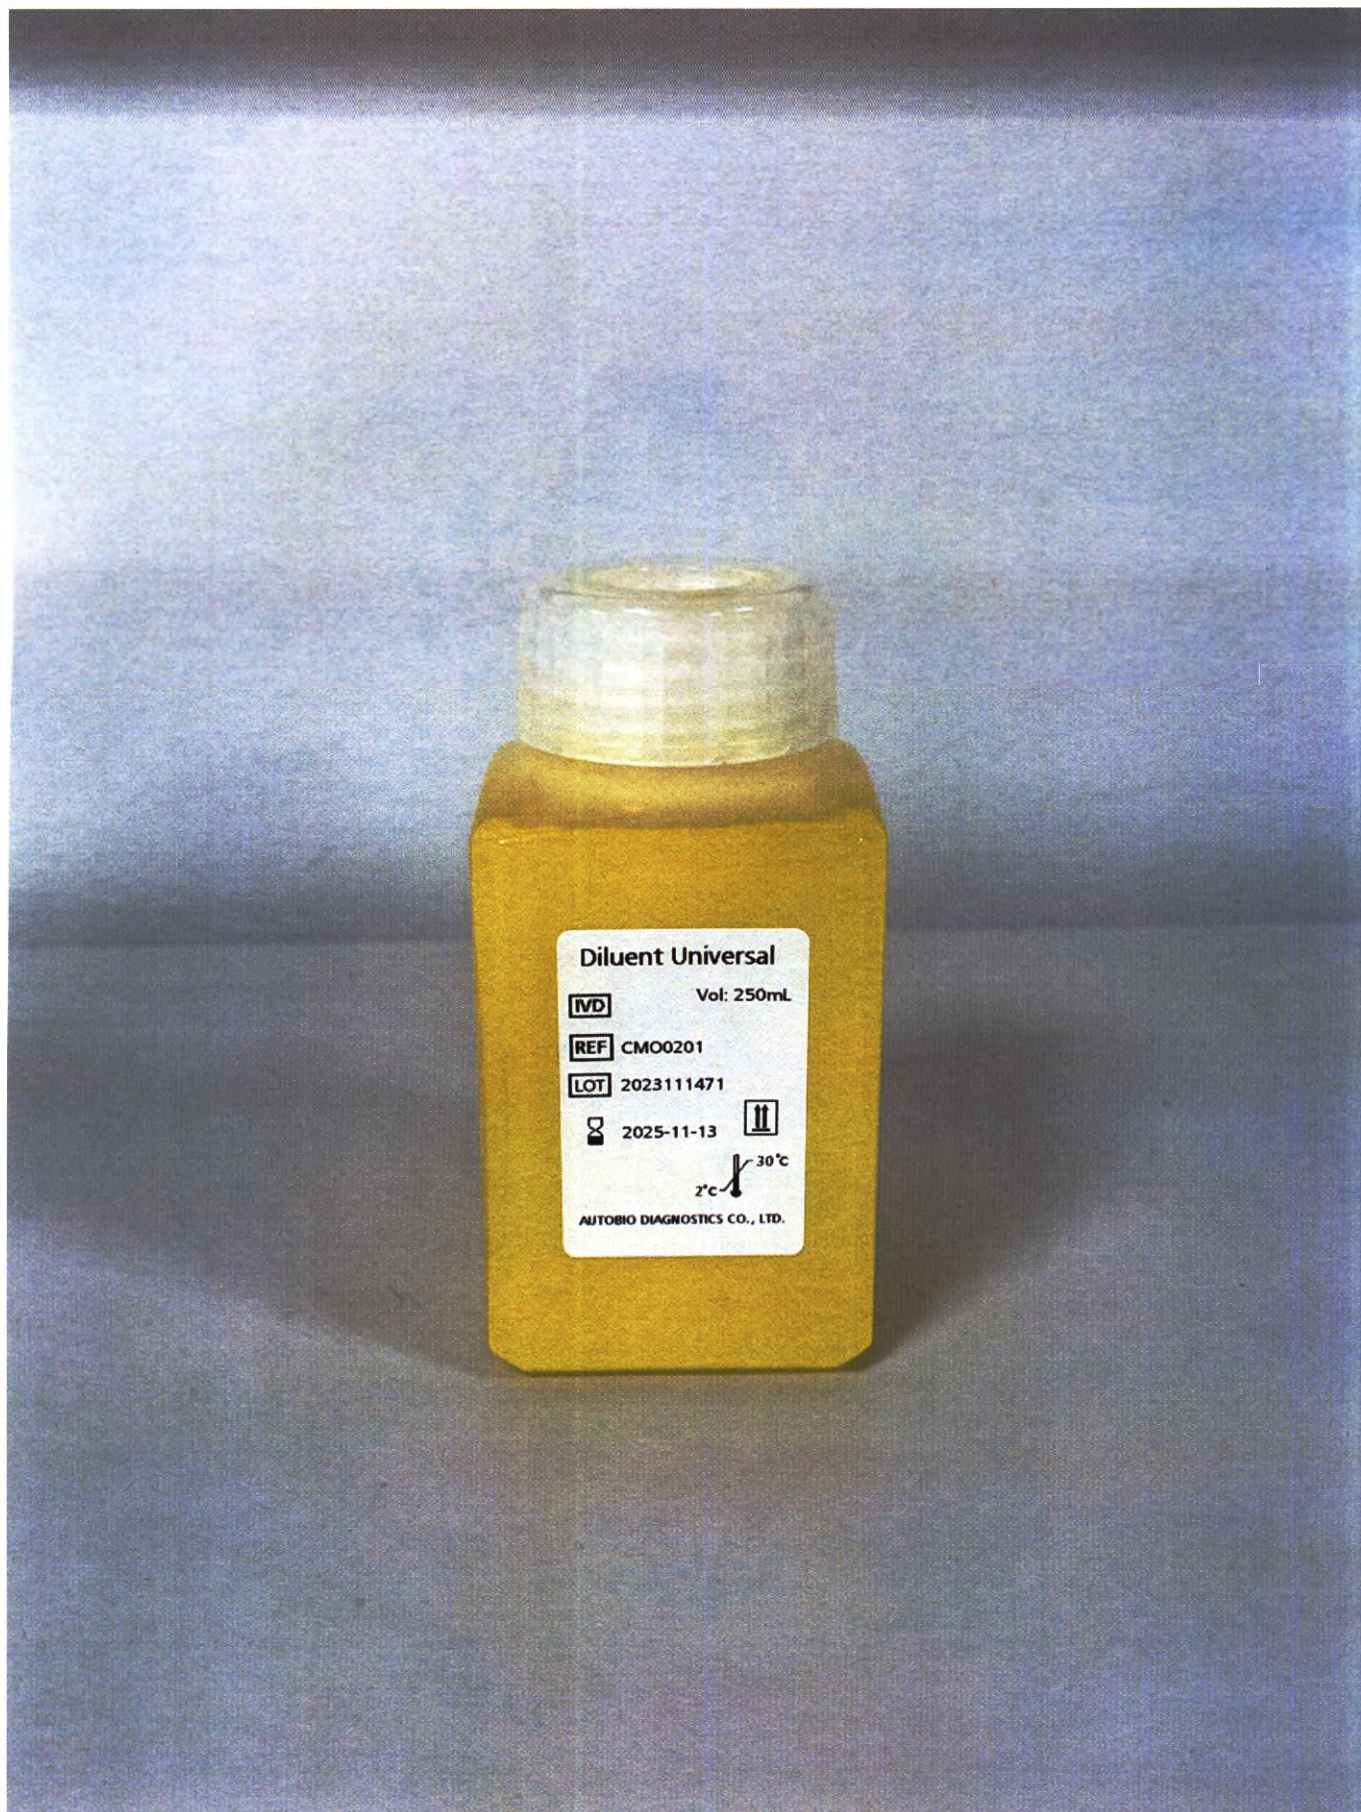

Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Макеты русскоязычной маркировки

Разбавитель образцов (Diluent Universal) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 202Х/XXXXХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Diluent Universal

250mL * 4 bottles


REF

CMO0201

LOT



IVD



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 6
(шесть) листах