



Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОФАЙЛ»

ИНН 7726423457 КПП 772601001

Адрес: 115230 Москва Варшавское шоссе, дом 46, стр. 6

Телефон: +7 (495) 540-58-95 e-mail: info@eurofiles.ru сайт: www.eurofiles.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Еврофайл»




Роджабова А.А.


Фотографические изображения №PMI-RD03-ФИ

Эндомотор для препарирования корневых каналов


1. Эндомотор беспроводной, модель ZR Touch New Generation

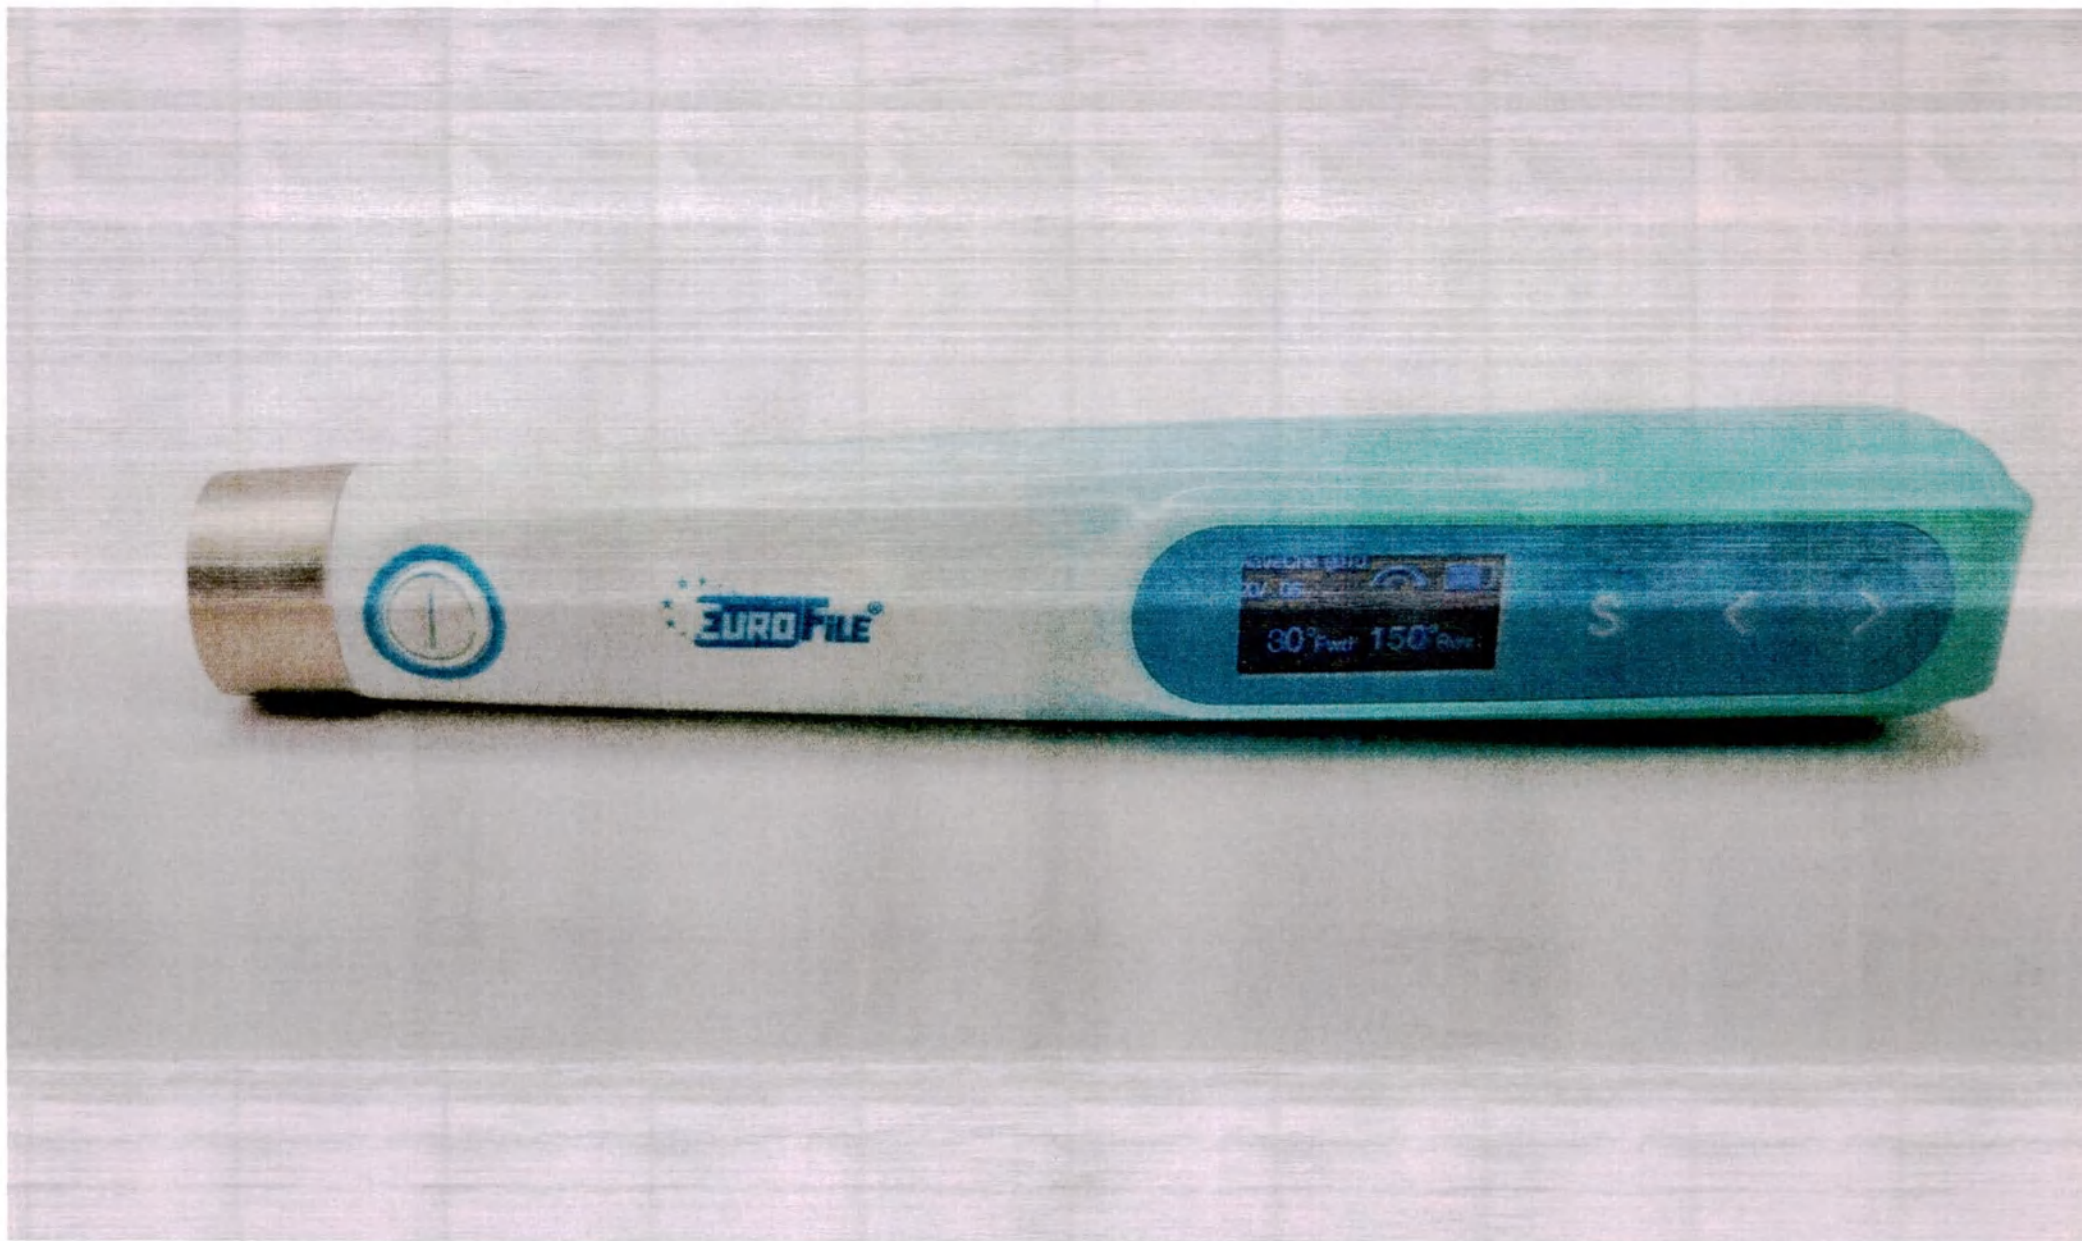


Фотографическое изображение 1 – Эндомотор беспроводной, модель ZR Touch New Generation (вид спереди)

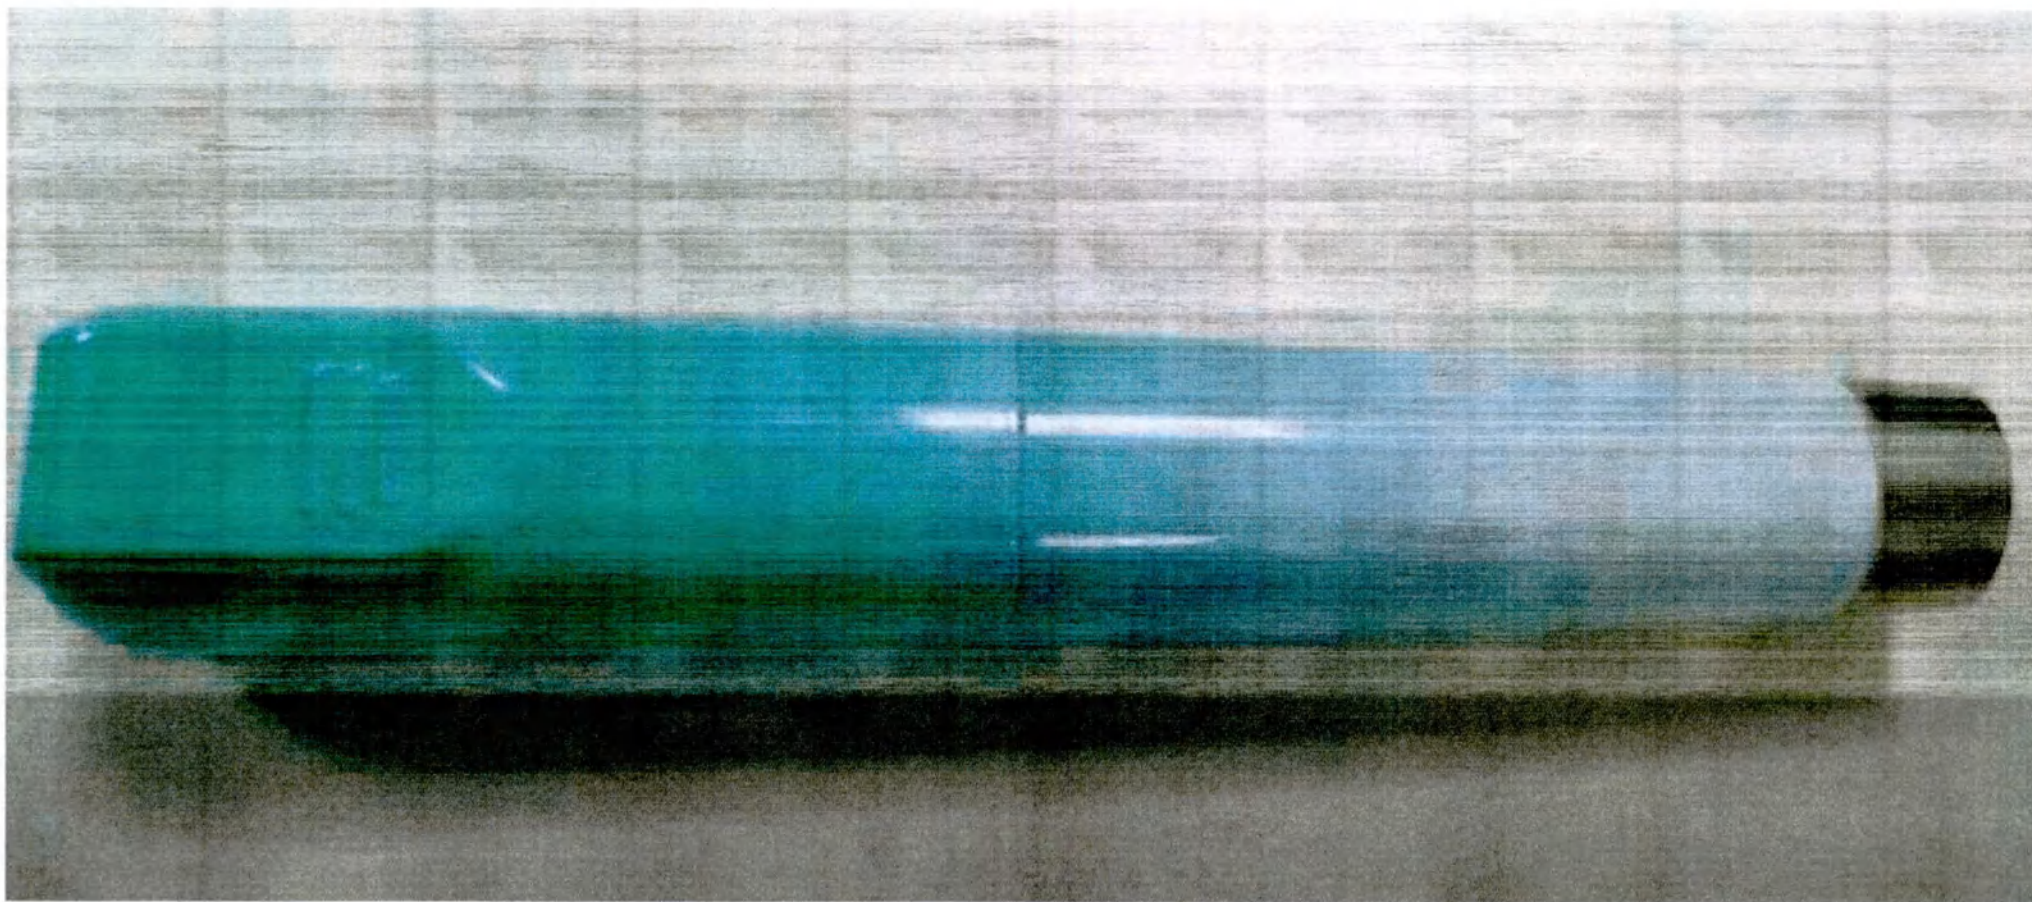


Фотографическое изображение 2 – Эндомотор беспроводной, модель ZR Touch New Generation (вид сзади)

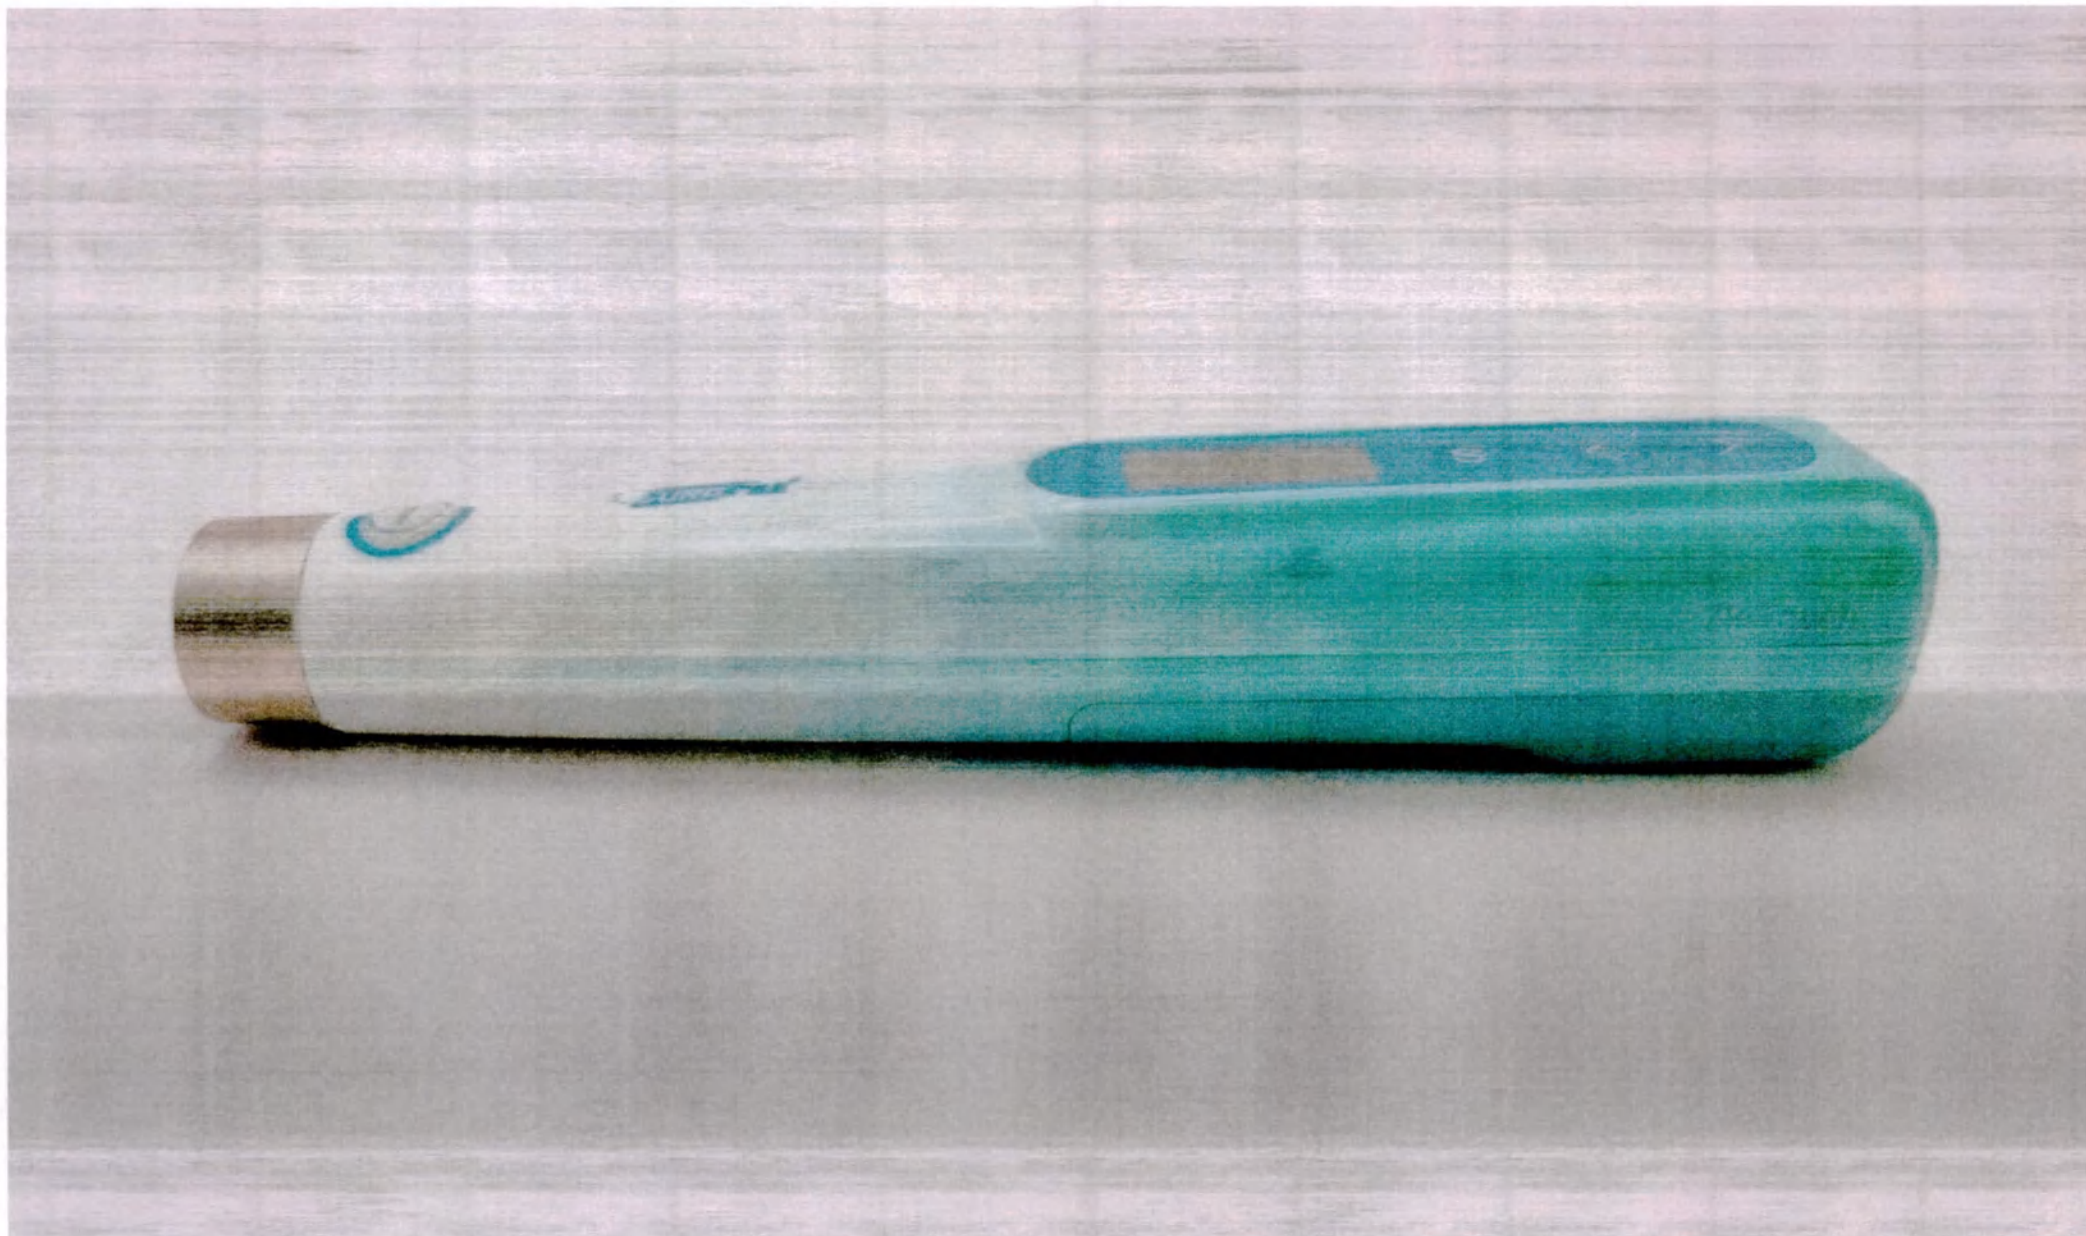

Фотографическое изображение 3 – Эндомотор беспроводной, модель ZR Touch New Generation (вид сбоку)

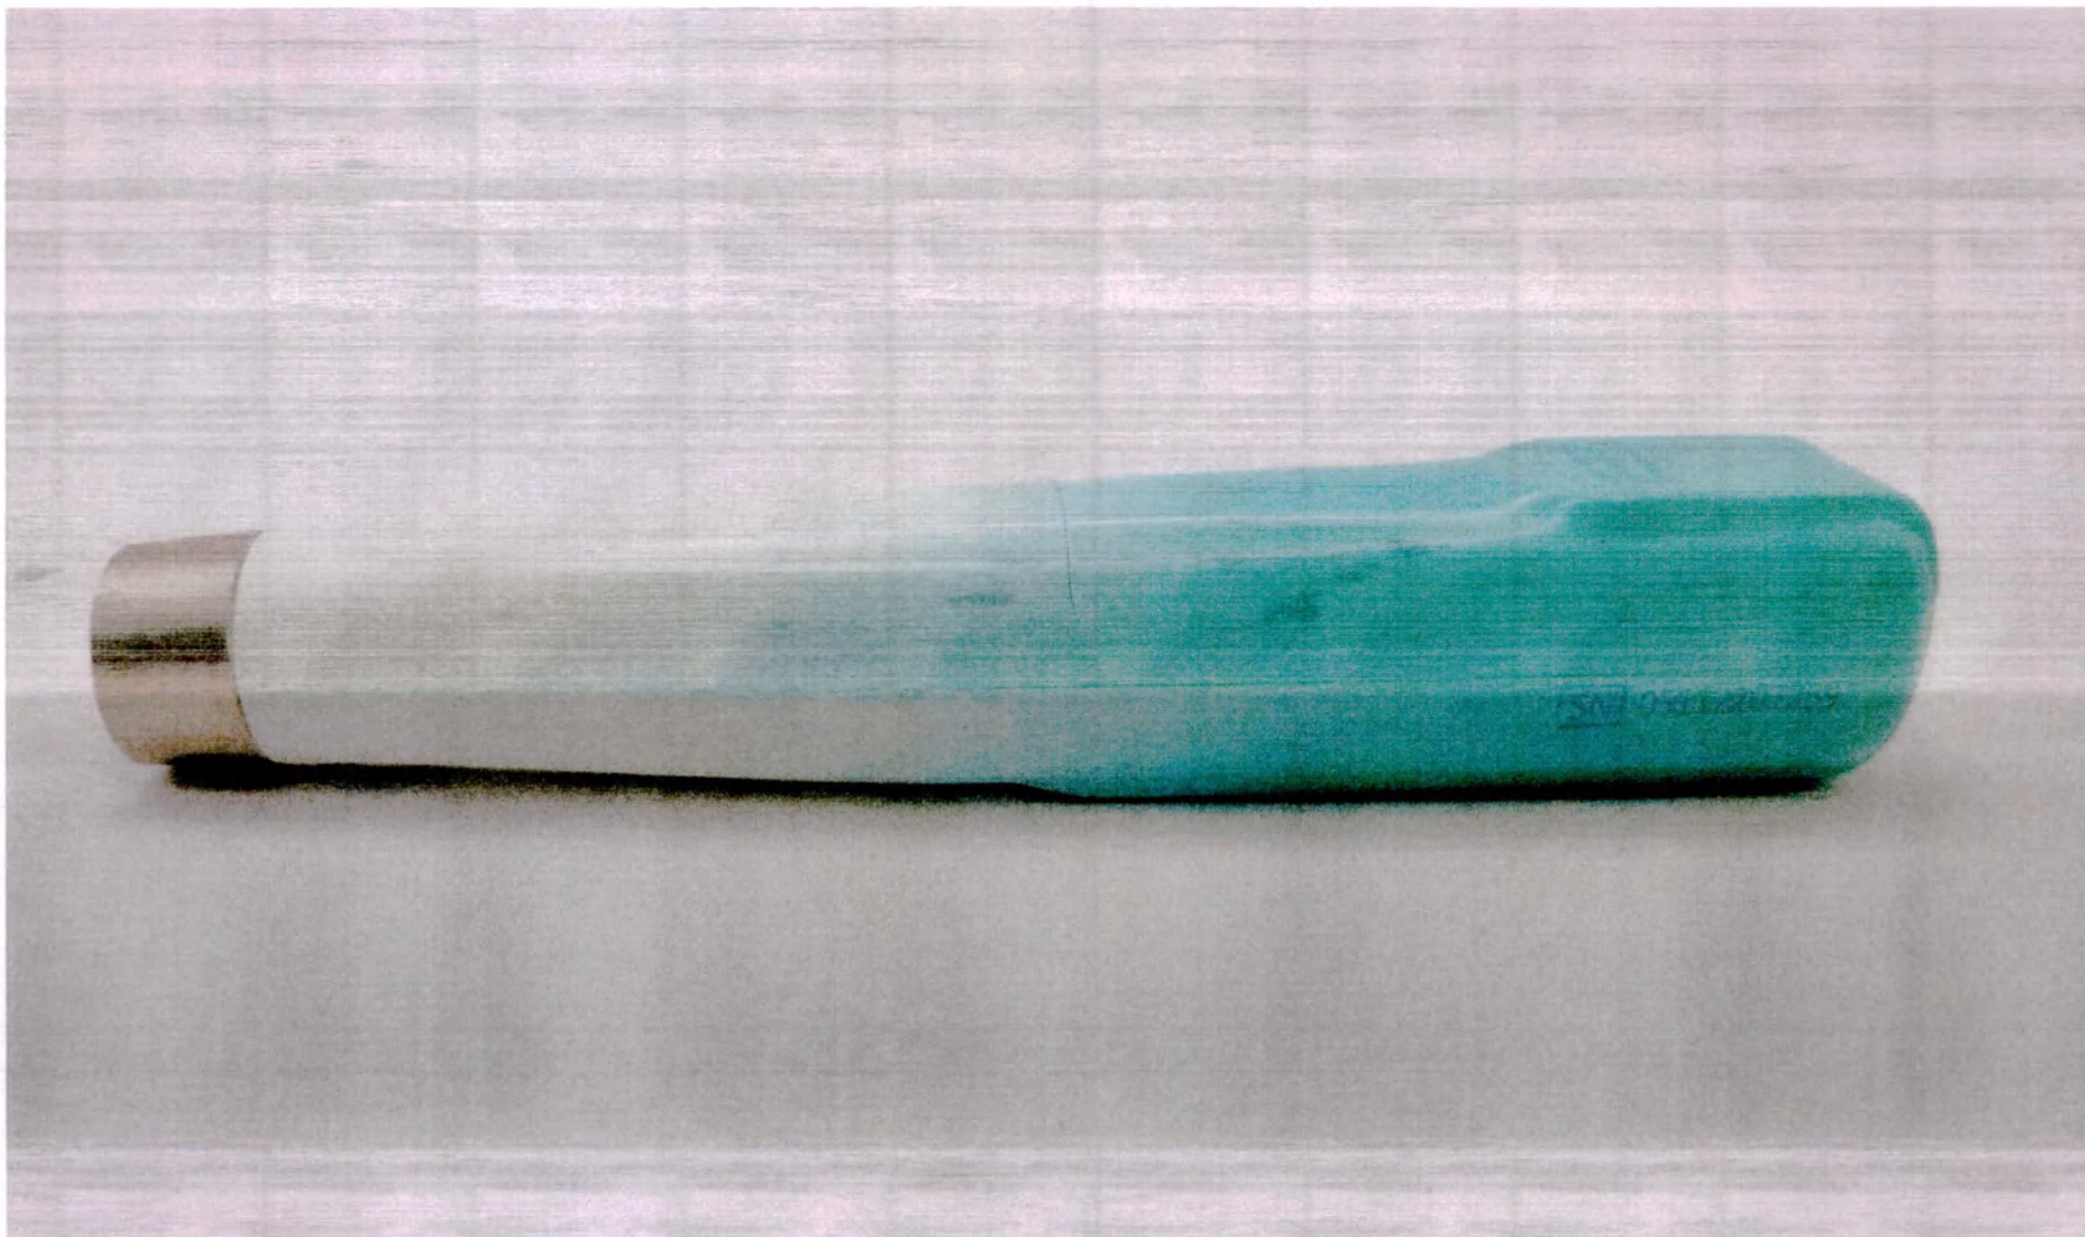


Фотографическое изображение 4 – Эндомотор беспроводной, модель ZR Touch New Generation (вид сбоку)

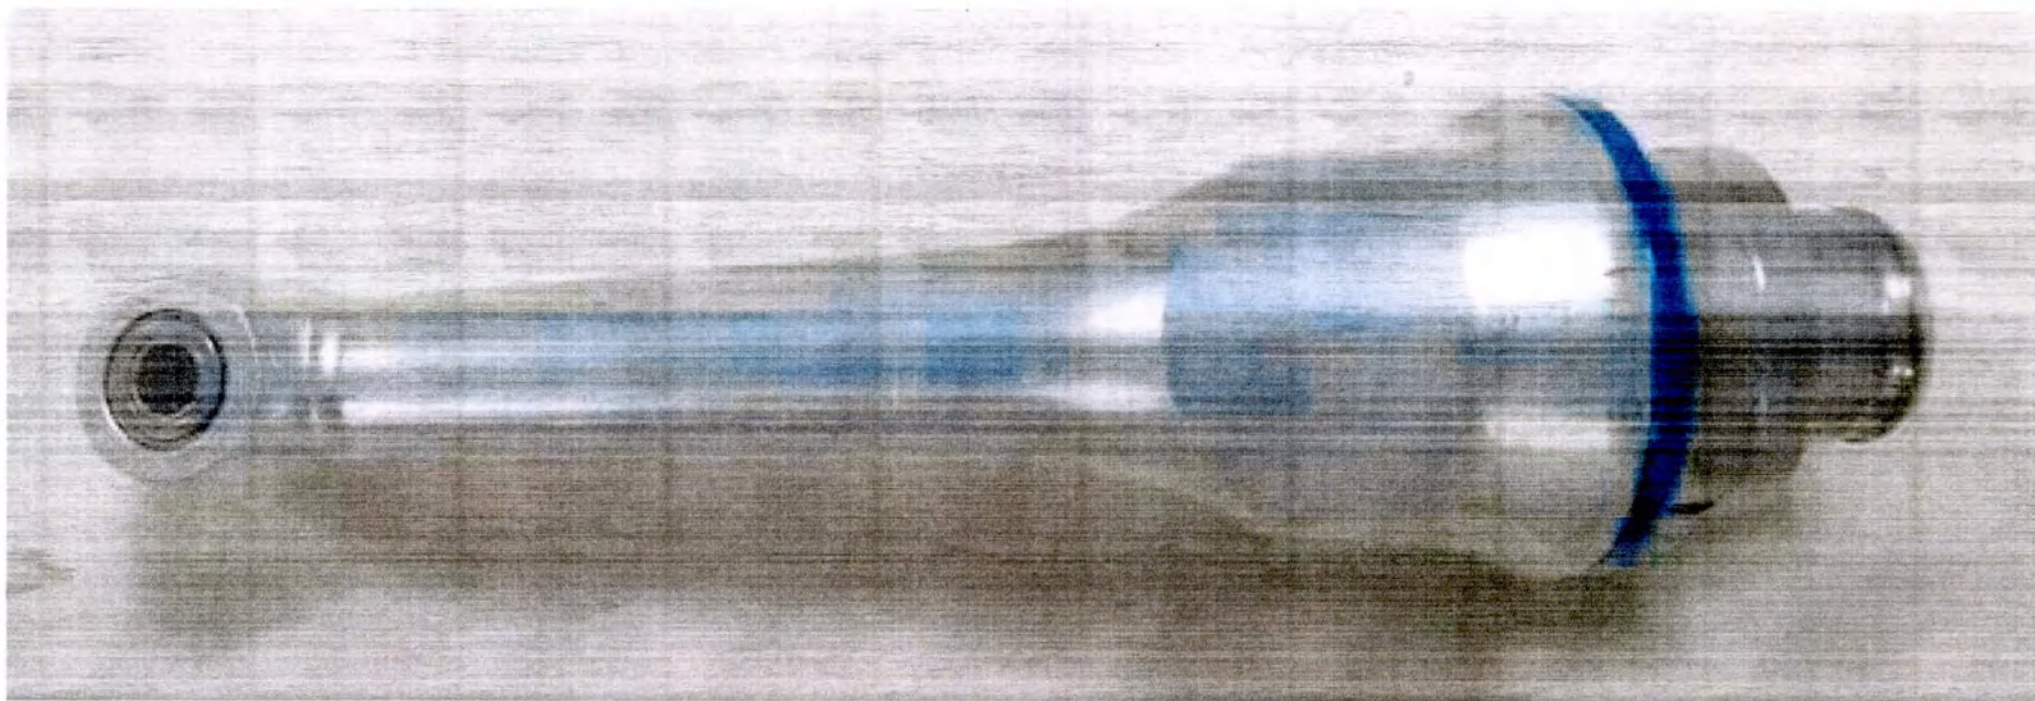


Фотографическое изображение 5 – Контругловый наконечник, модель E-BCA11-A (вид спереди)



Фотографическое изображение 6 – Контругловый наконечник, модель E-BCA11-A (вид сзади)

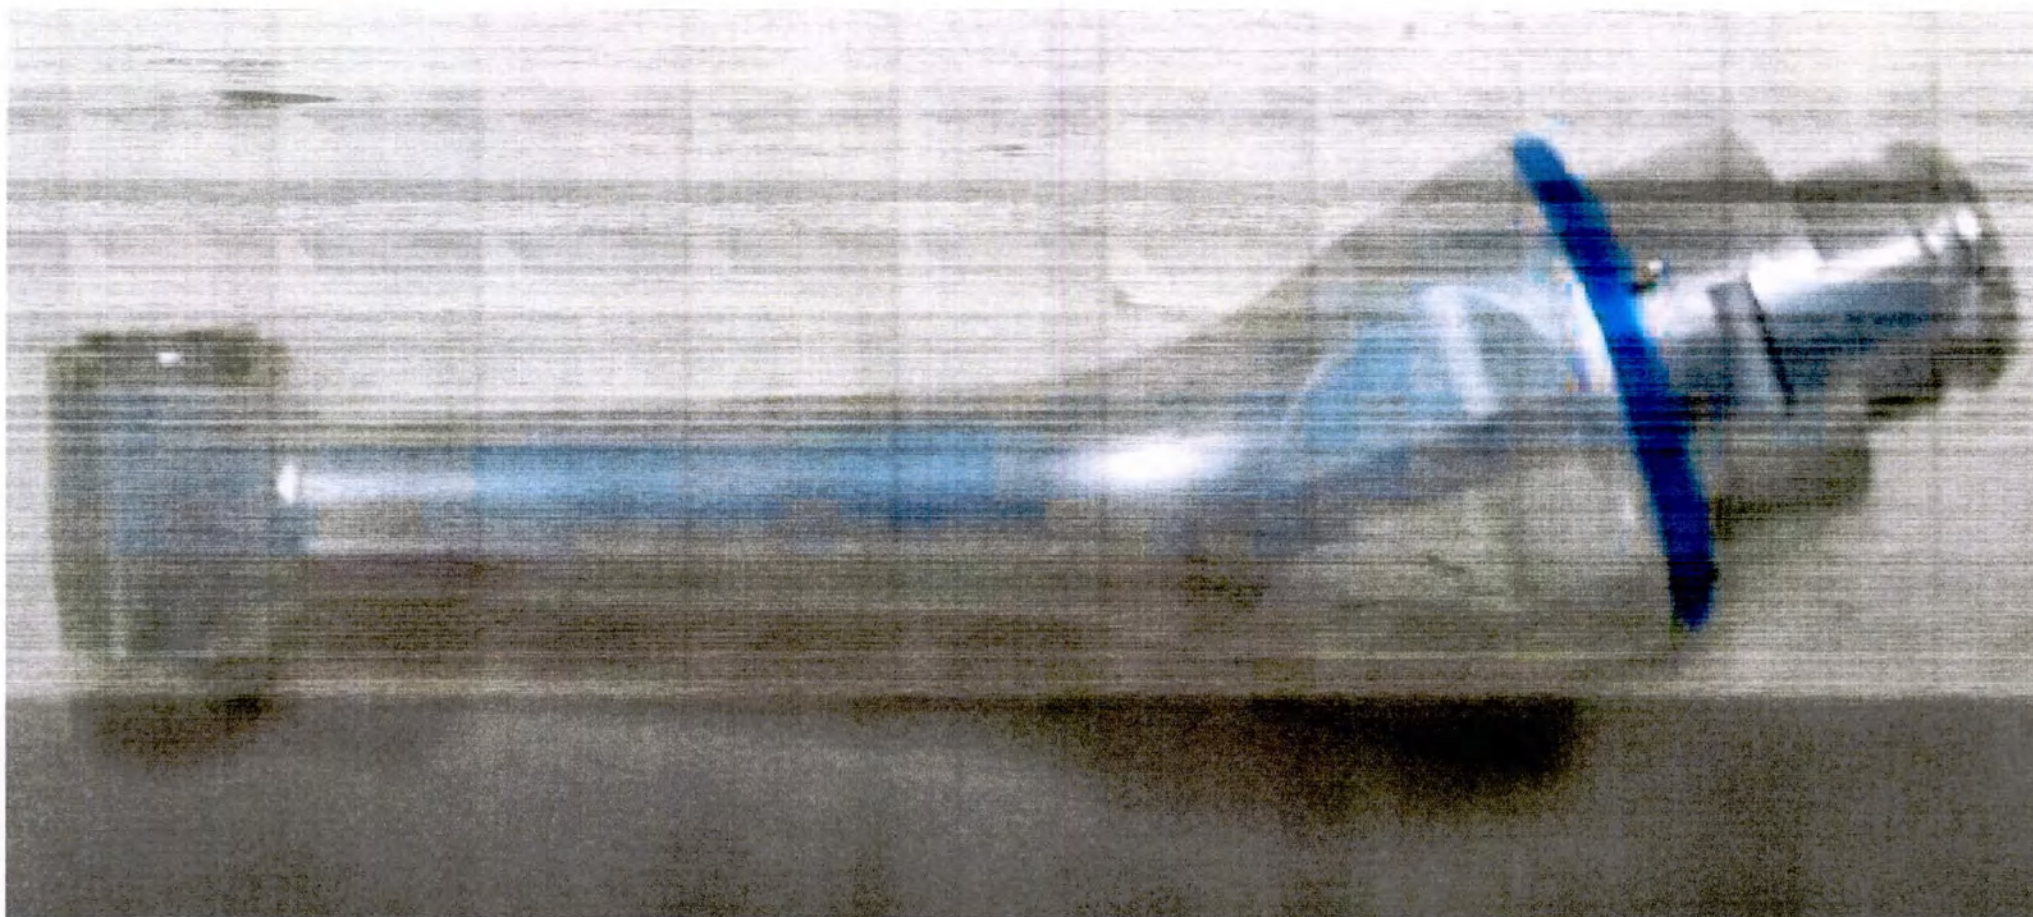


Фотографическое изображение 7 – Контругловый наконечник, модель E-BCA11-A (вид сбоку)

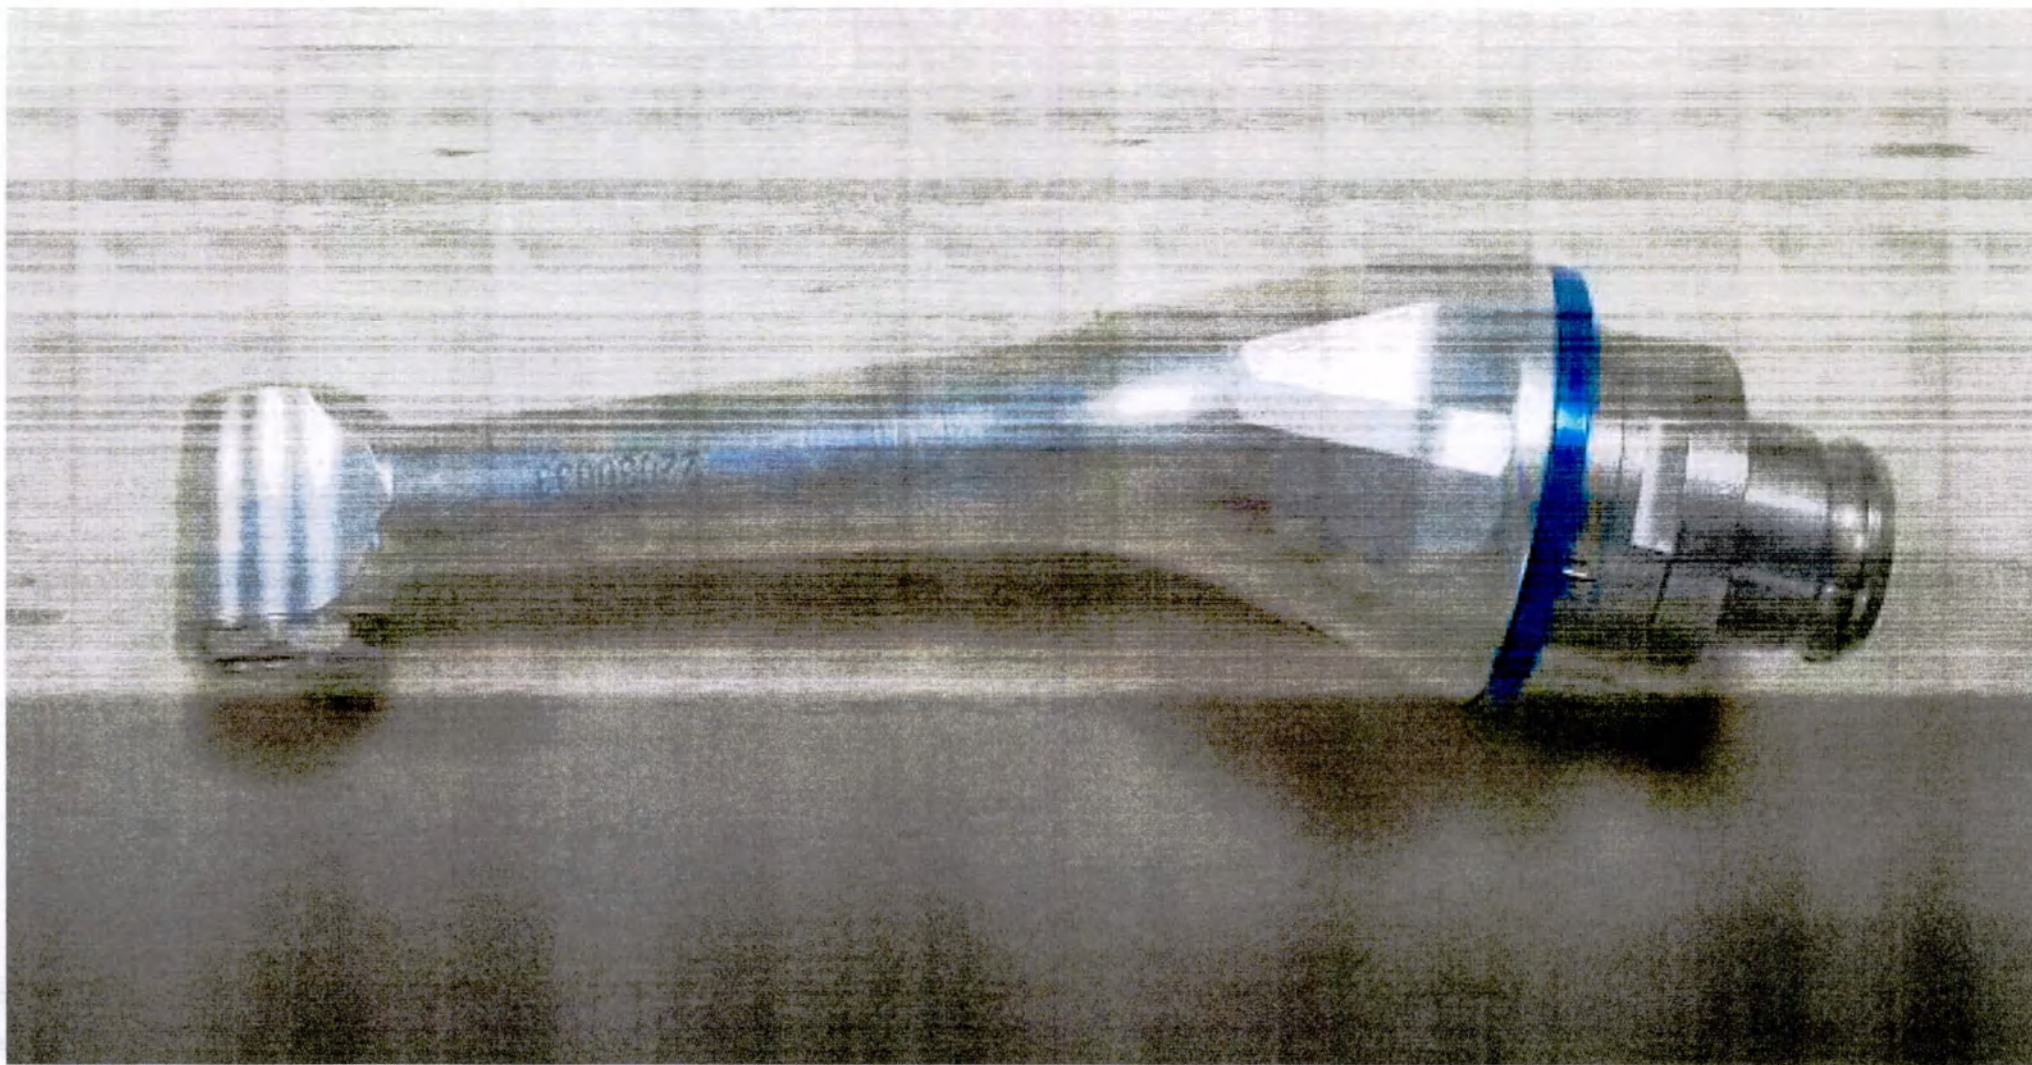


Фотографическое изображение 8 – Контругловый наконечник, модель E-BCA11-A (вид сбоку)




Фотографическое изображение 9 – Контругловый наконечник, модель E-BCA11-A (в упаковке)

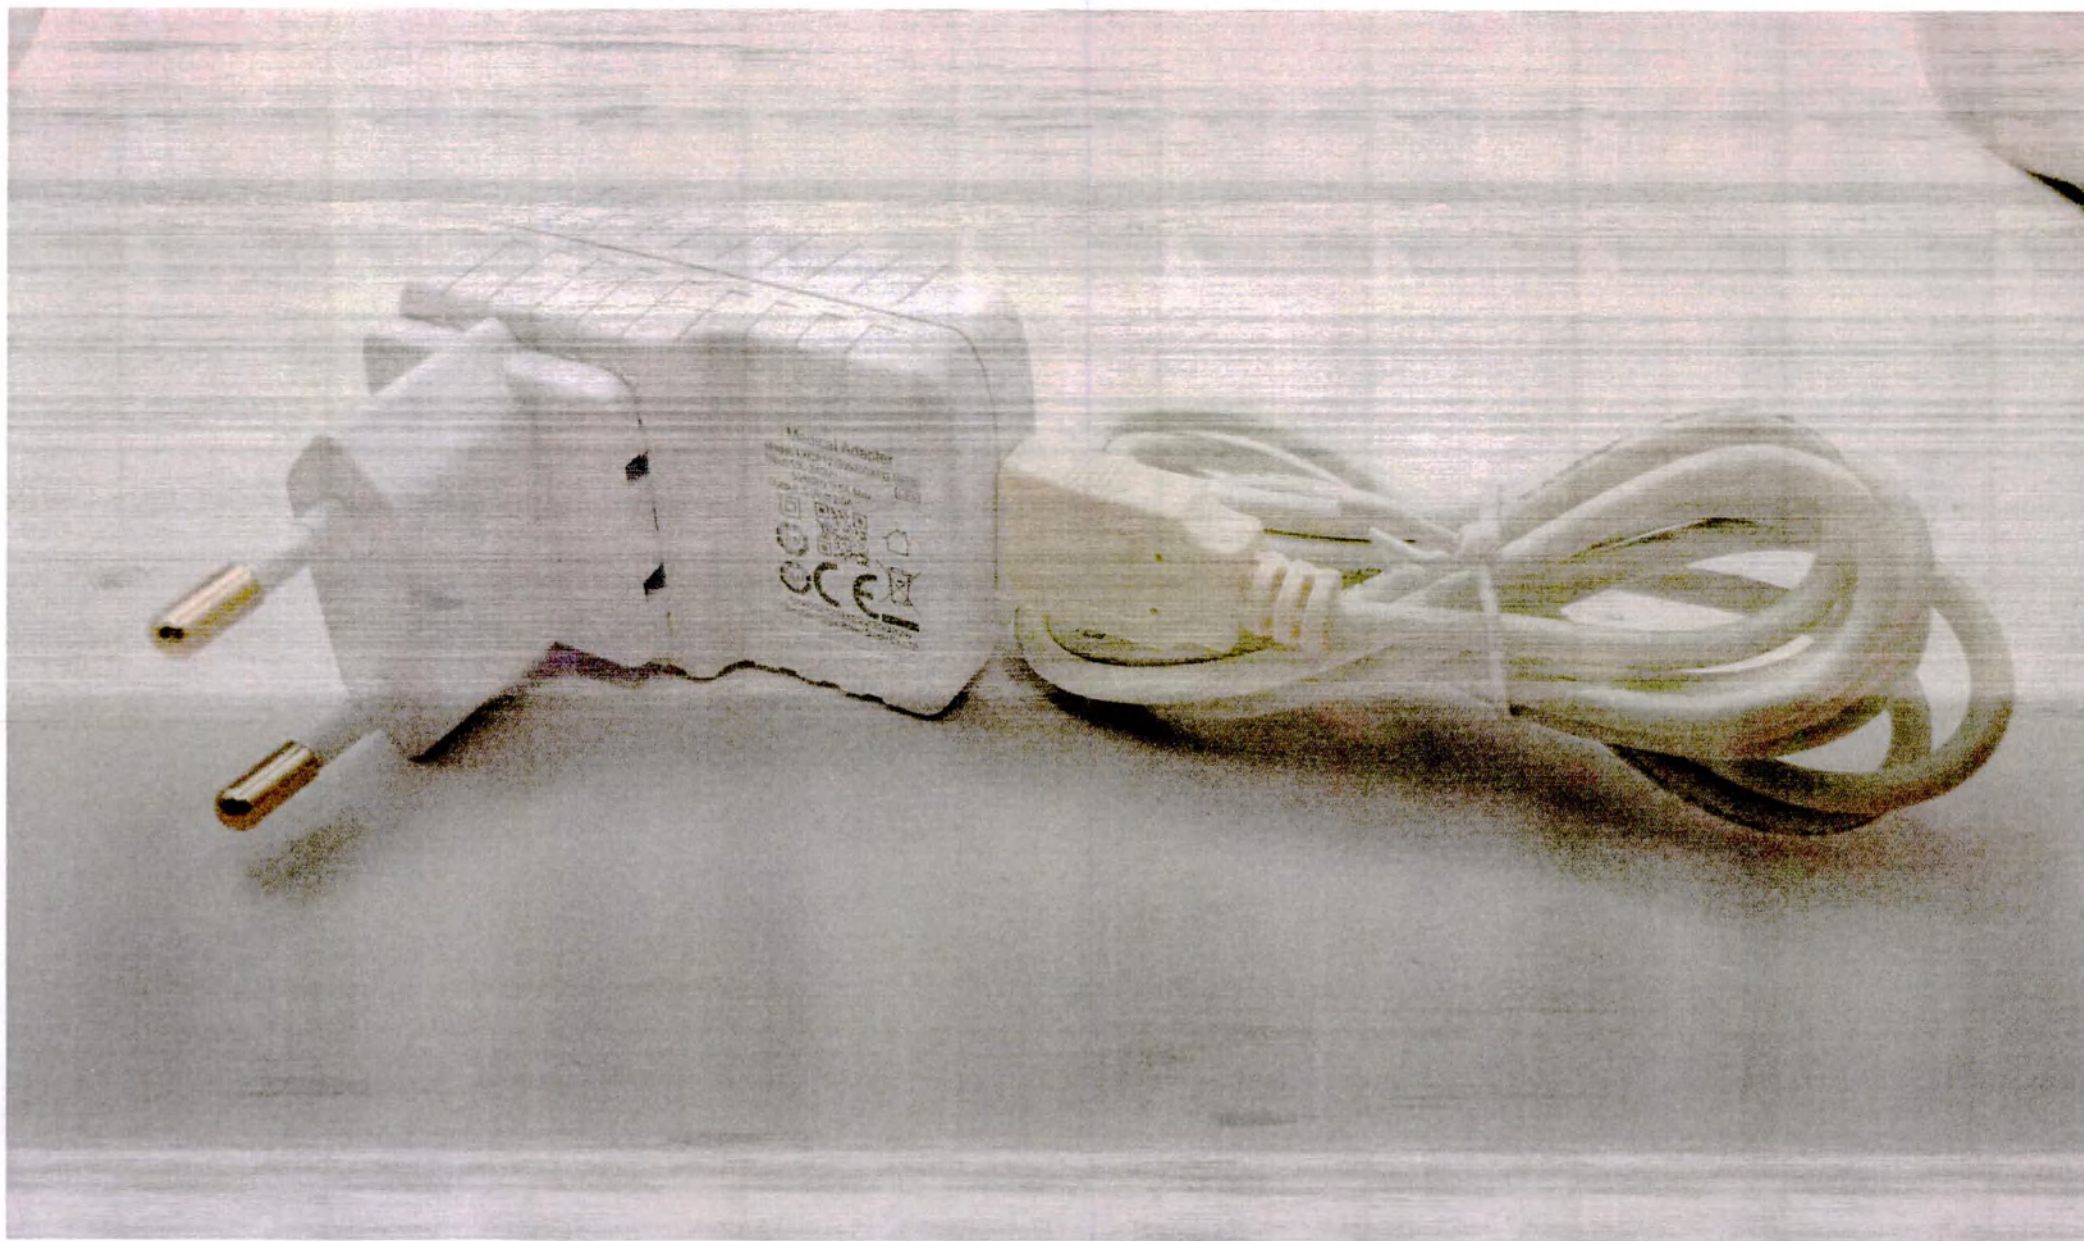


Фотографическое изображение 10 – Адаптер питания в составе

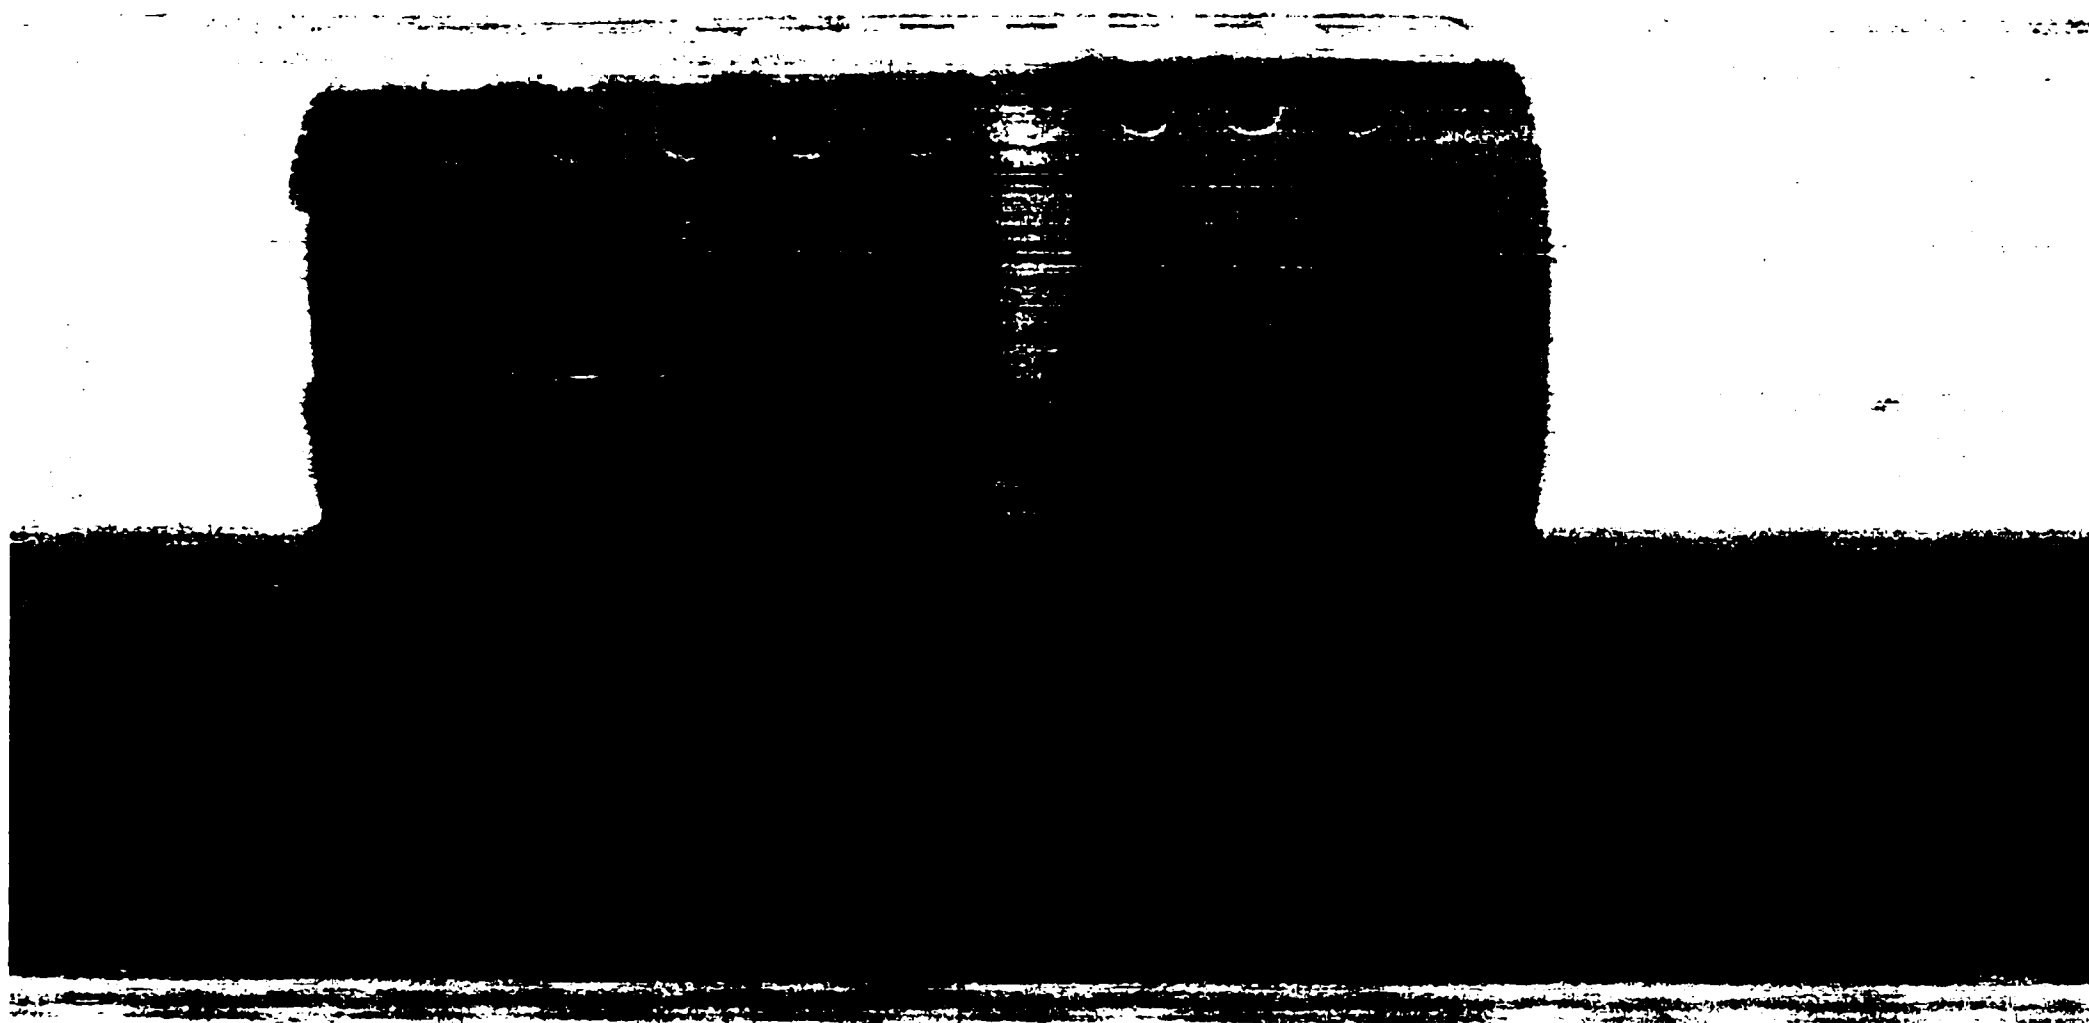

Фотографическое изображение 11 Адаптер питания

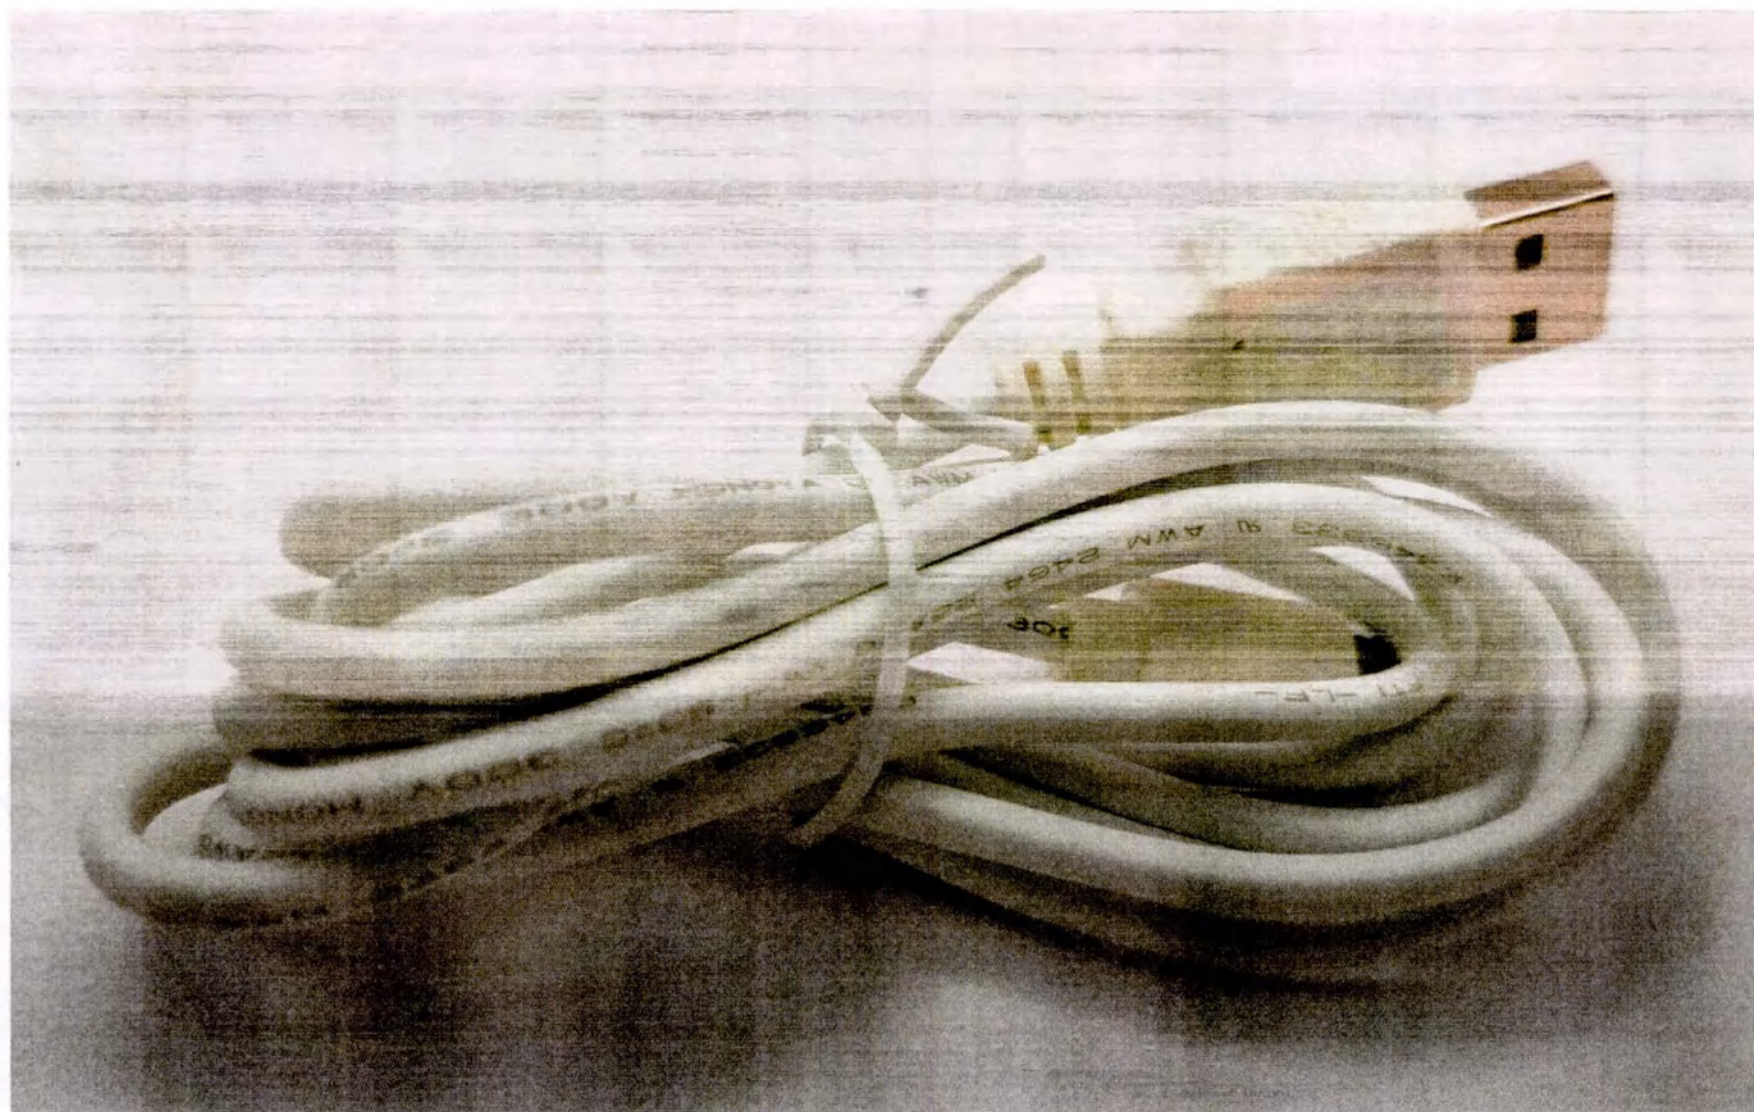


Фотографическое изображение 12 – Кабель питания

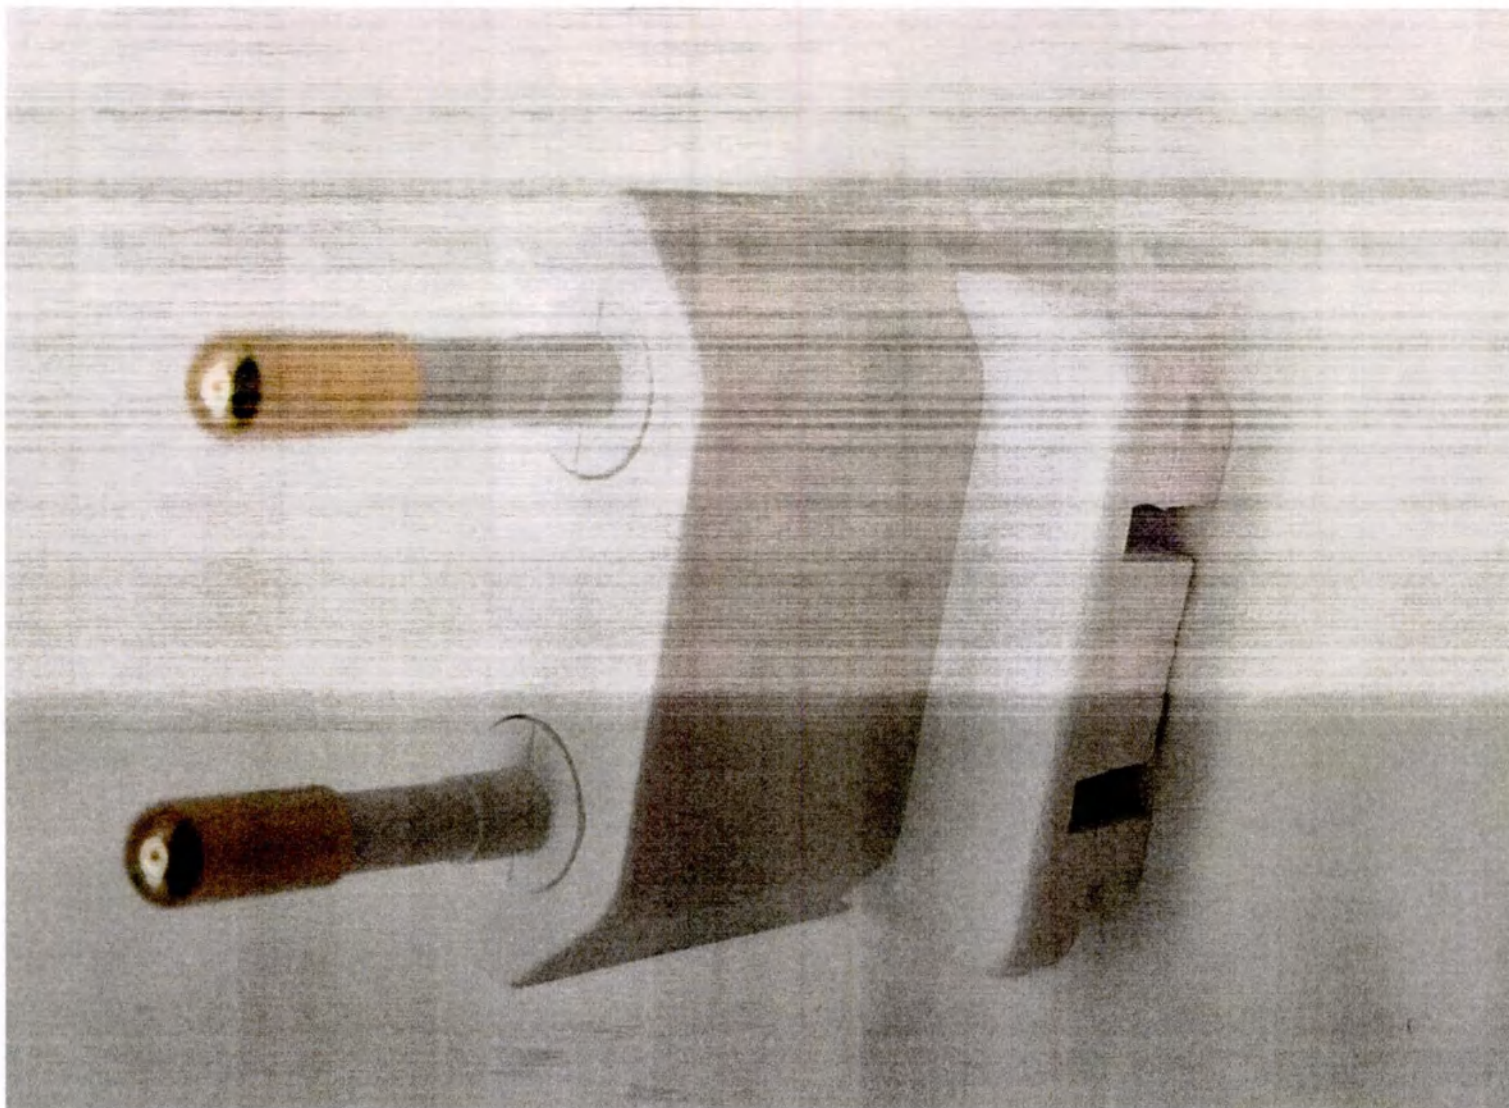


Фотографическое изображение 13 – Переходник для адаптера питания




Фотографическое изображение 14 – Подставка с эндомотором (общий вид)

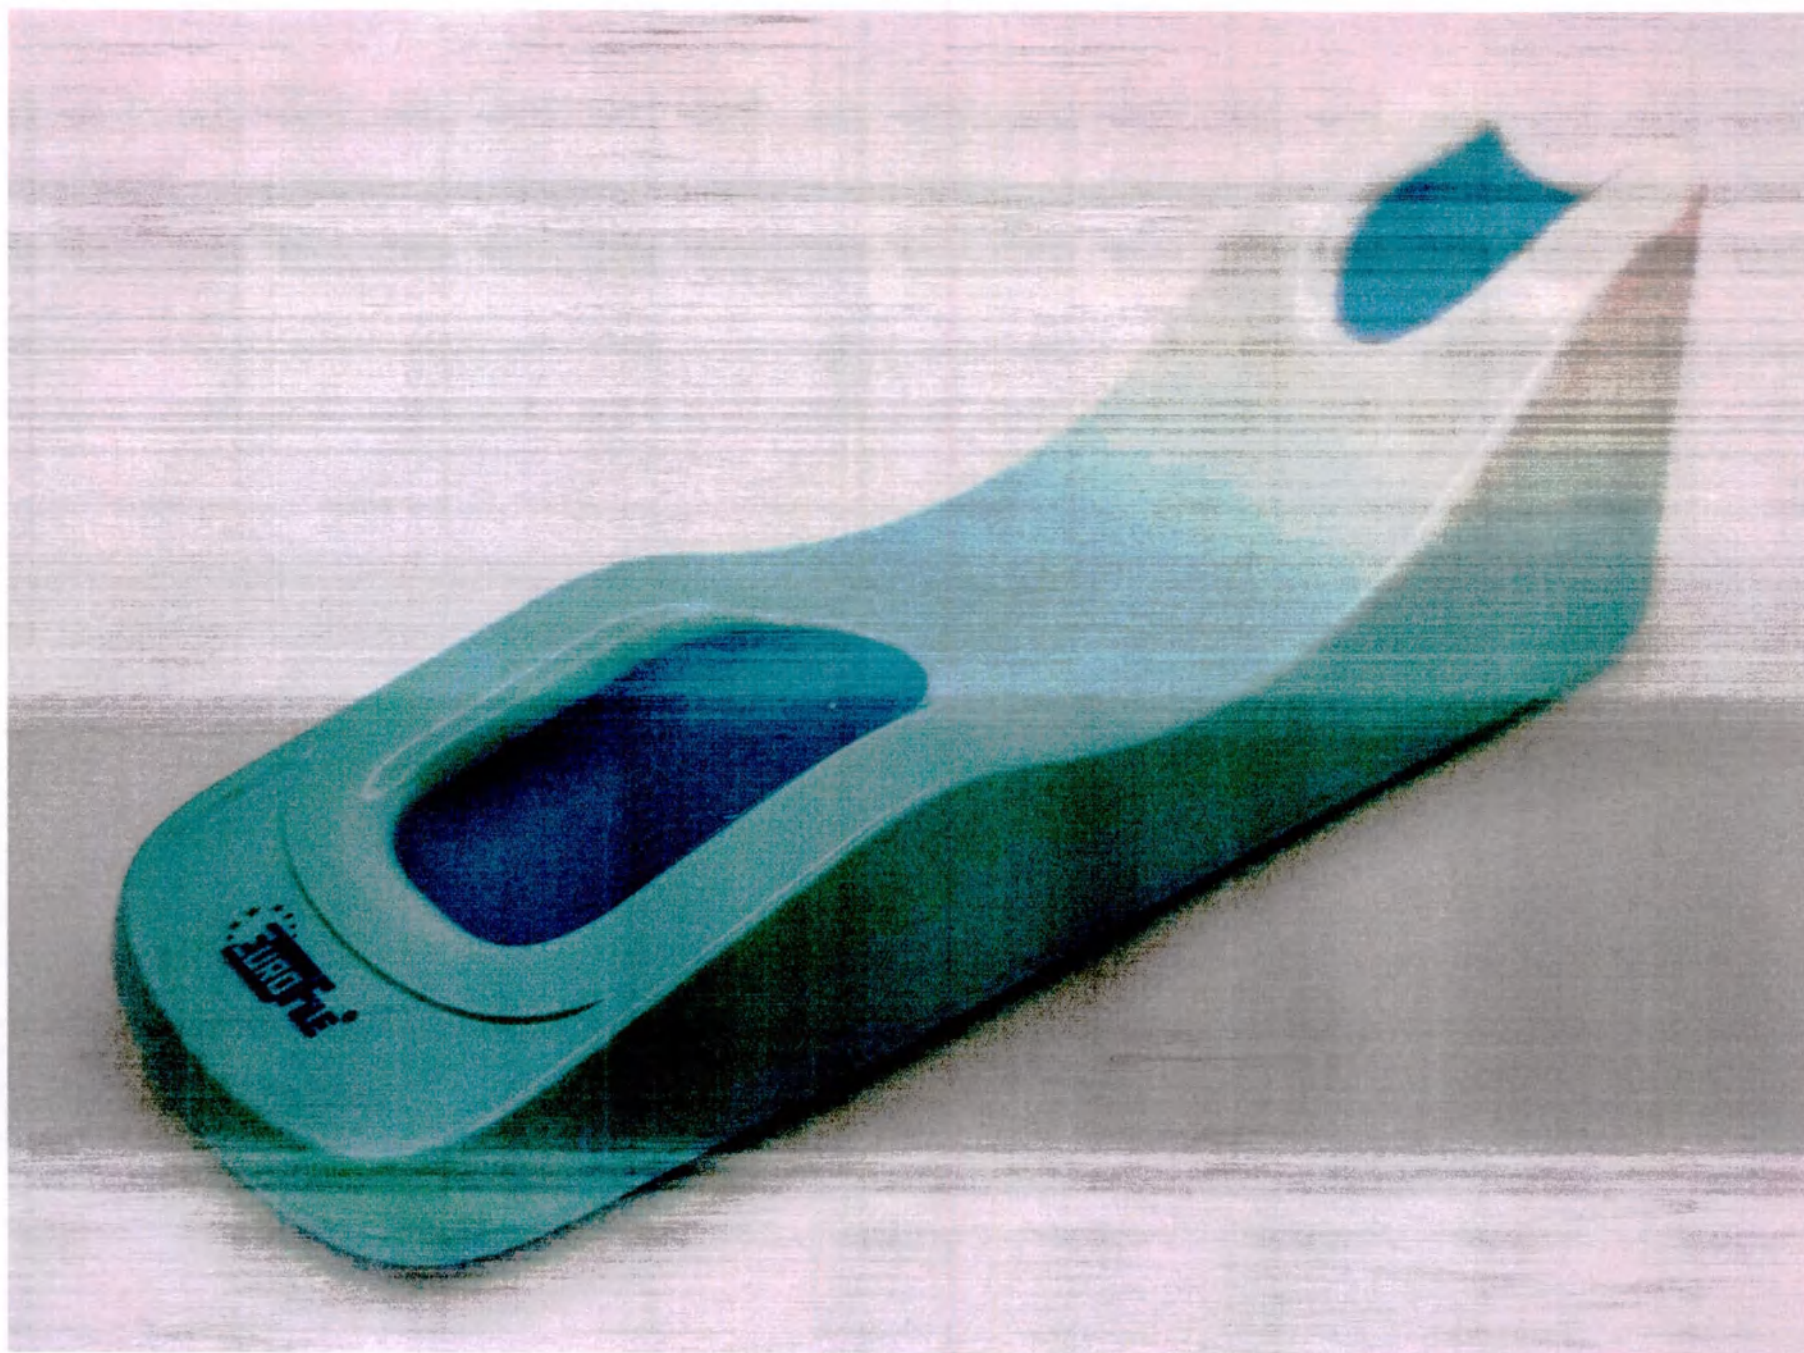


Фотографическое изображение 15 – Подставка

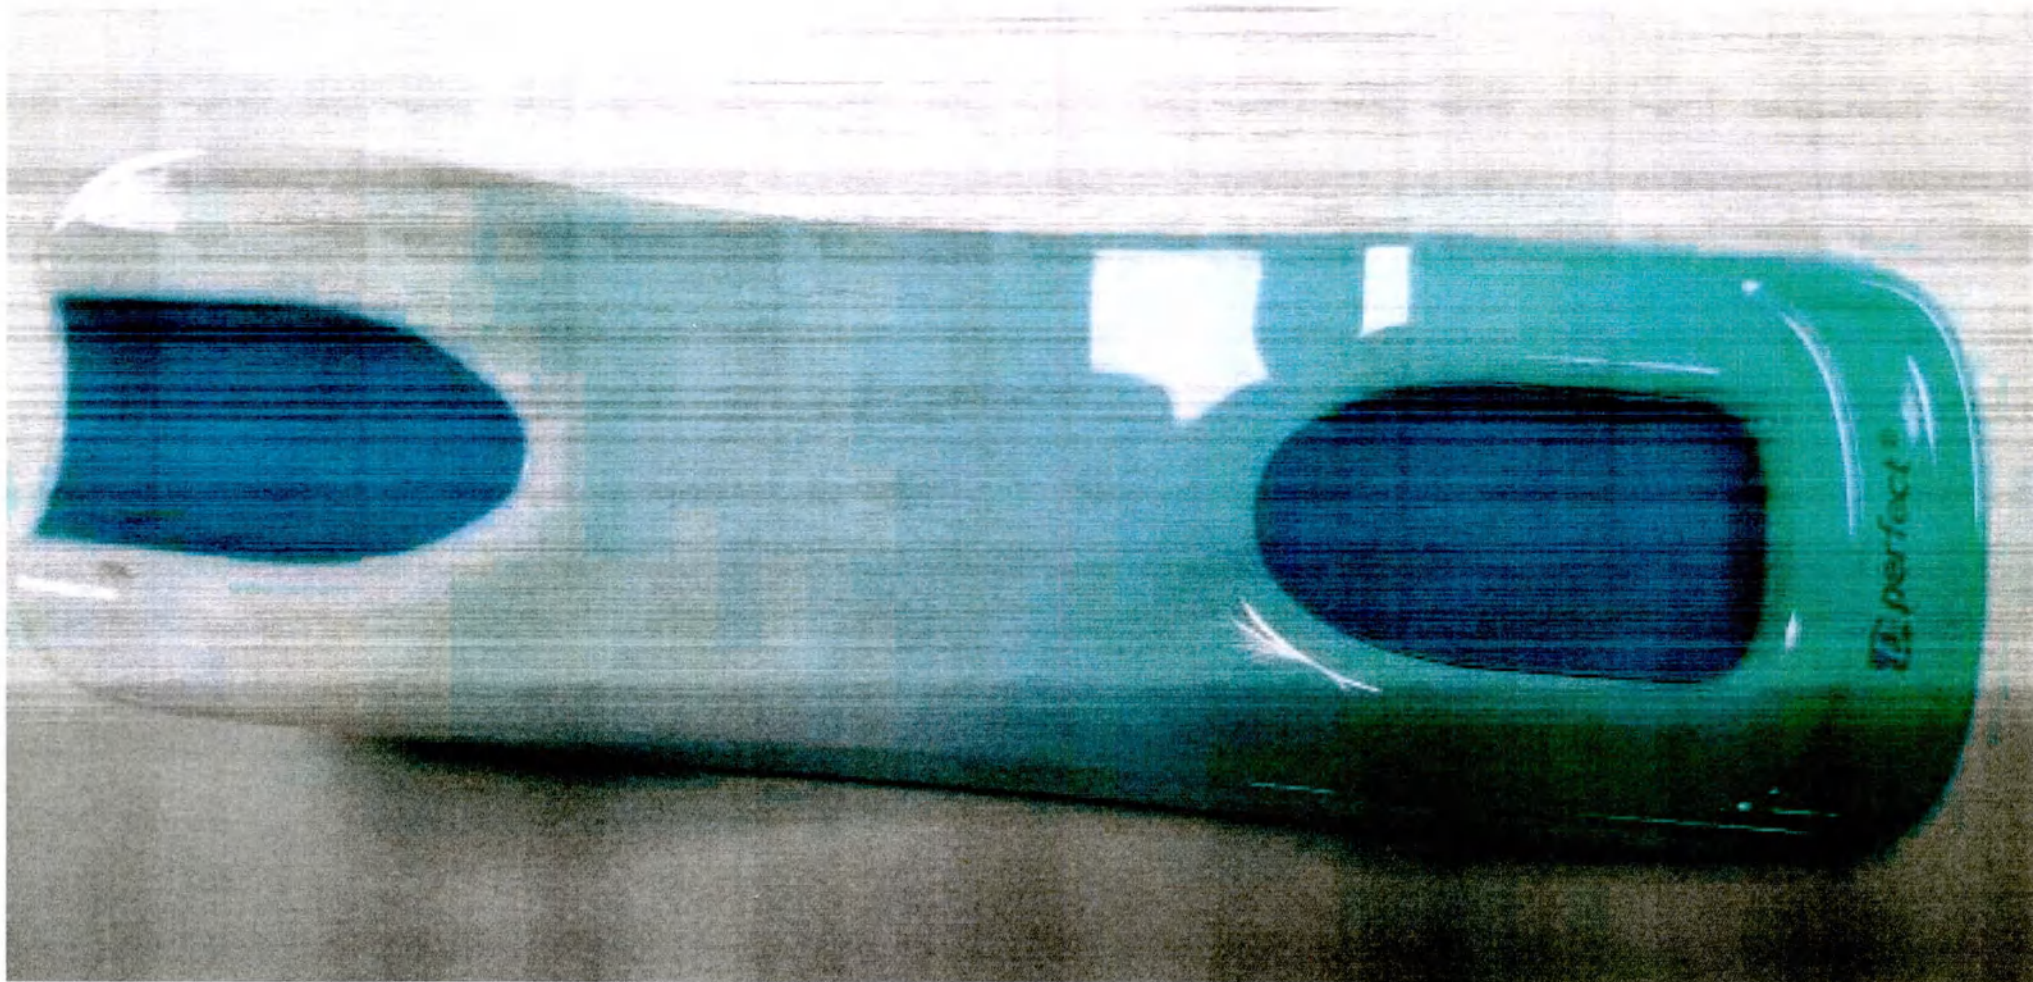


Фотографическое изображение 16 – Подставка (вид сверху)

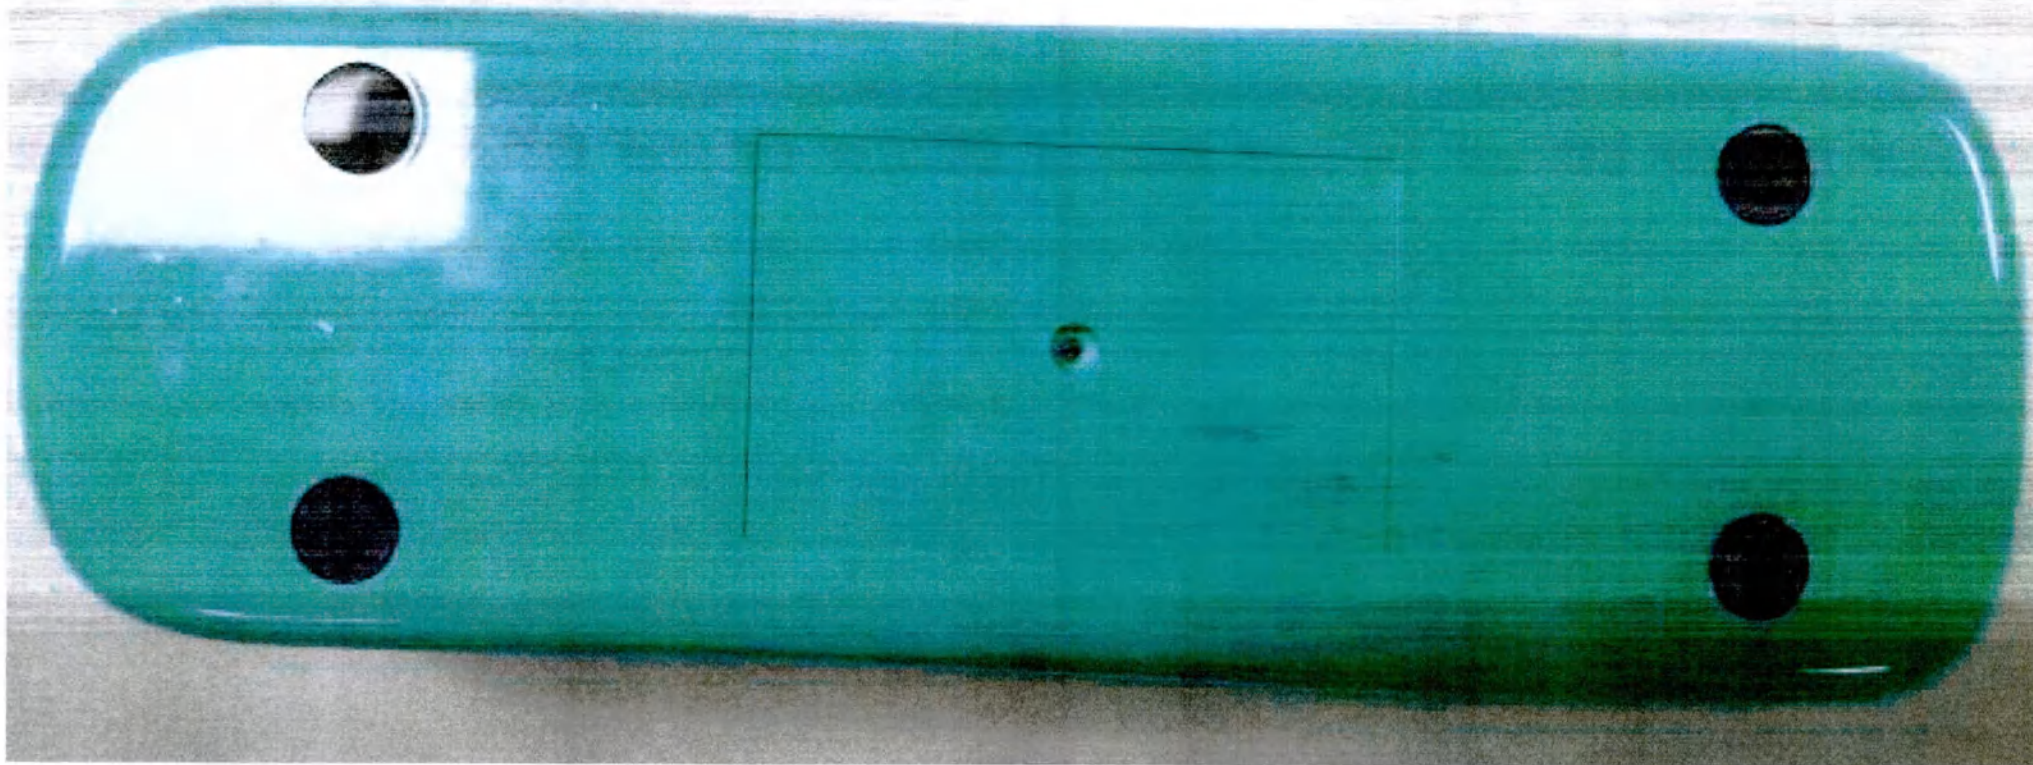

Фотографическое изображение 17 – Подставка (вид снизу)

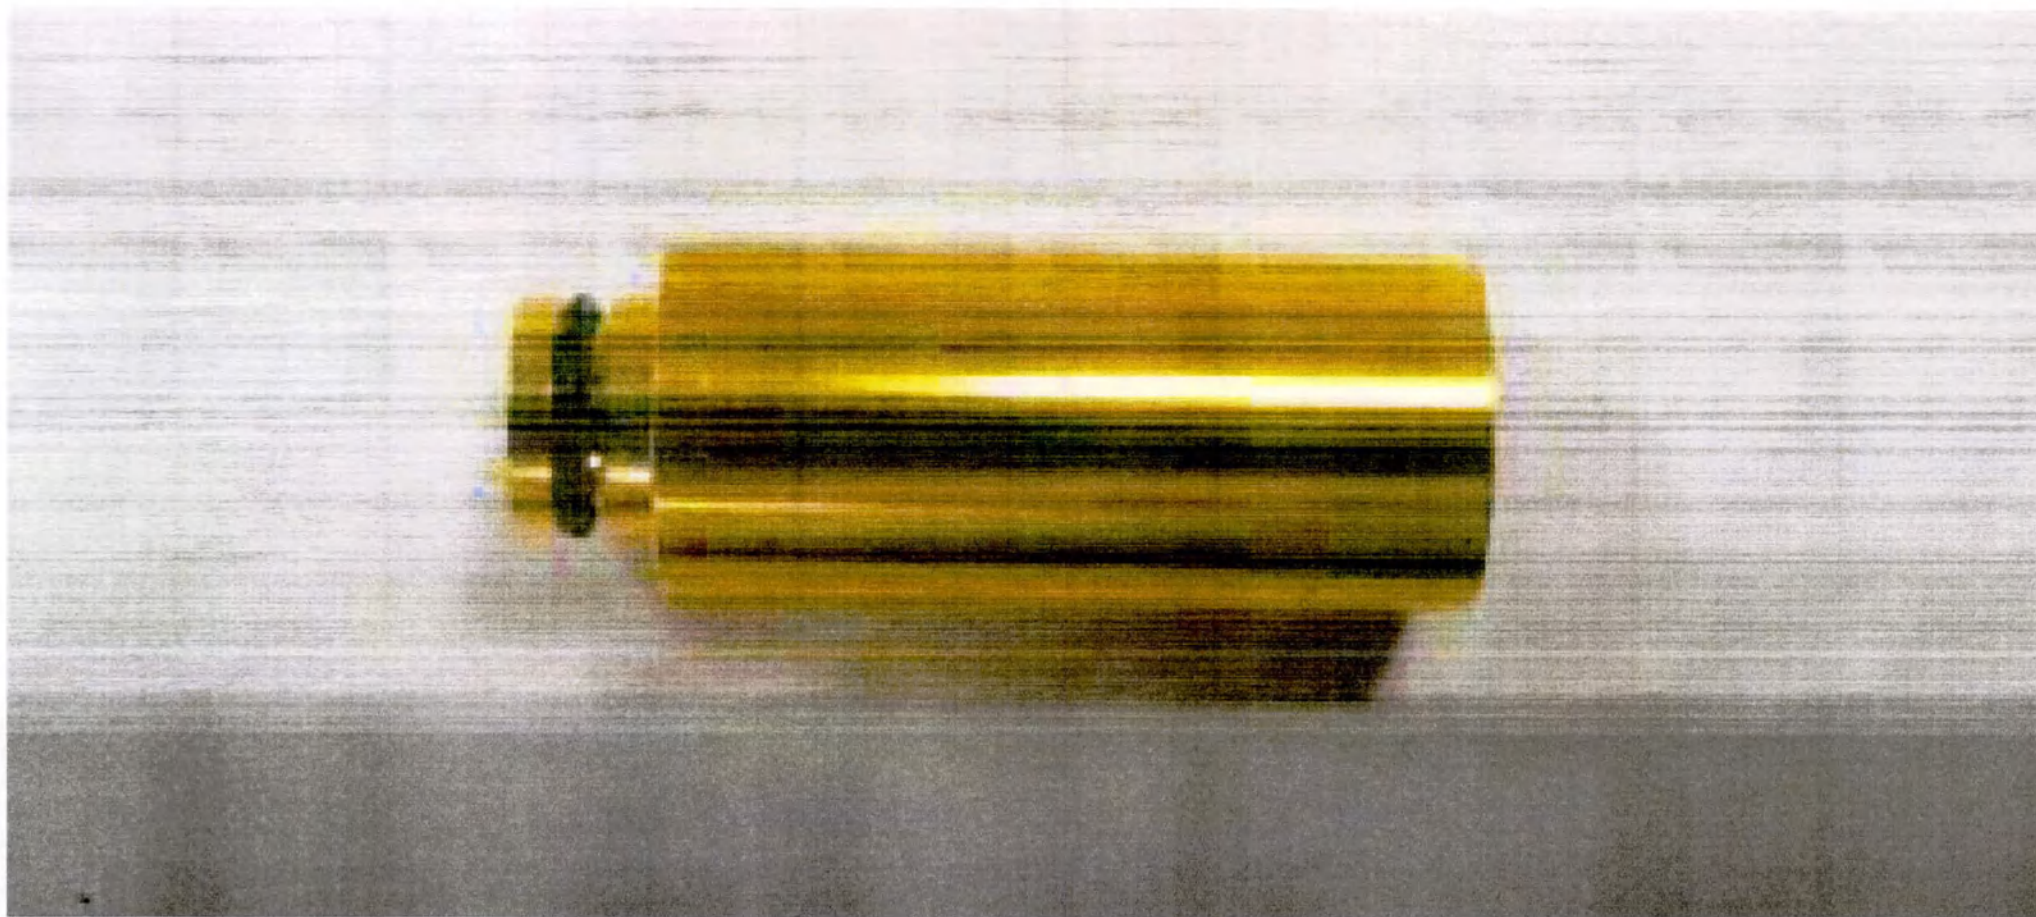


Фотографическое изображение 18 – Масляная форсунка

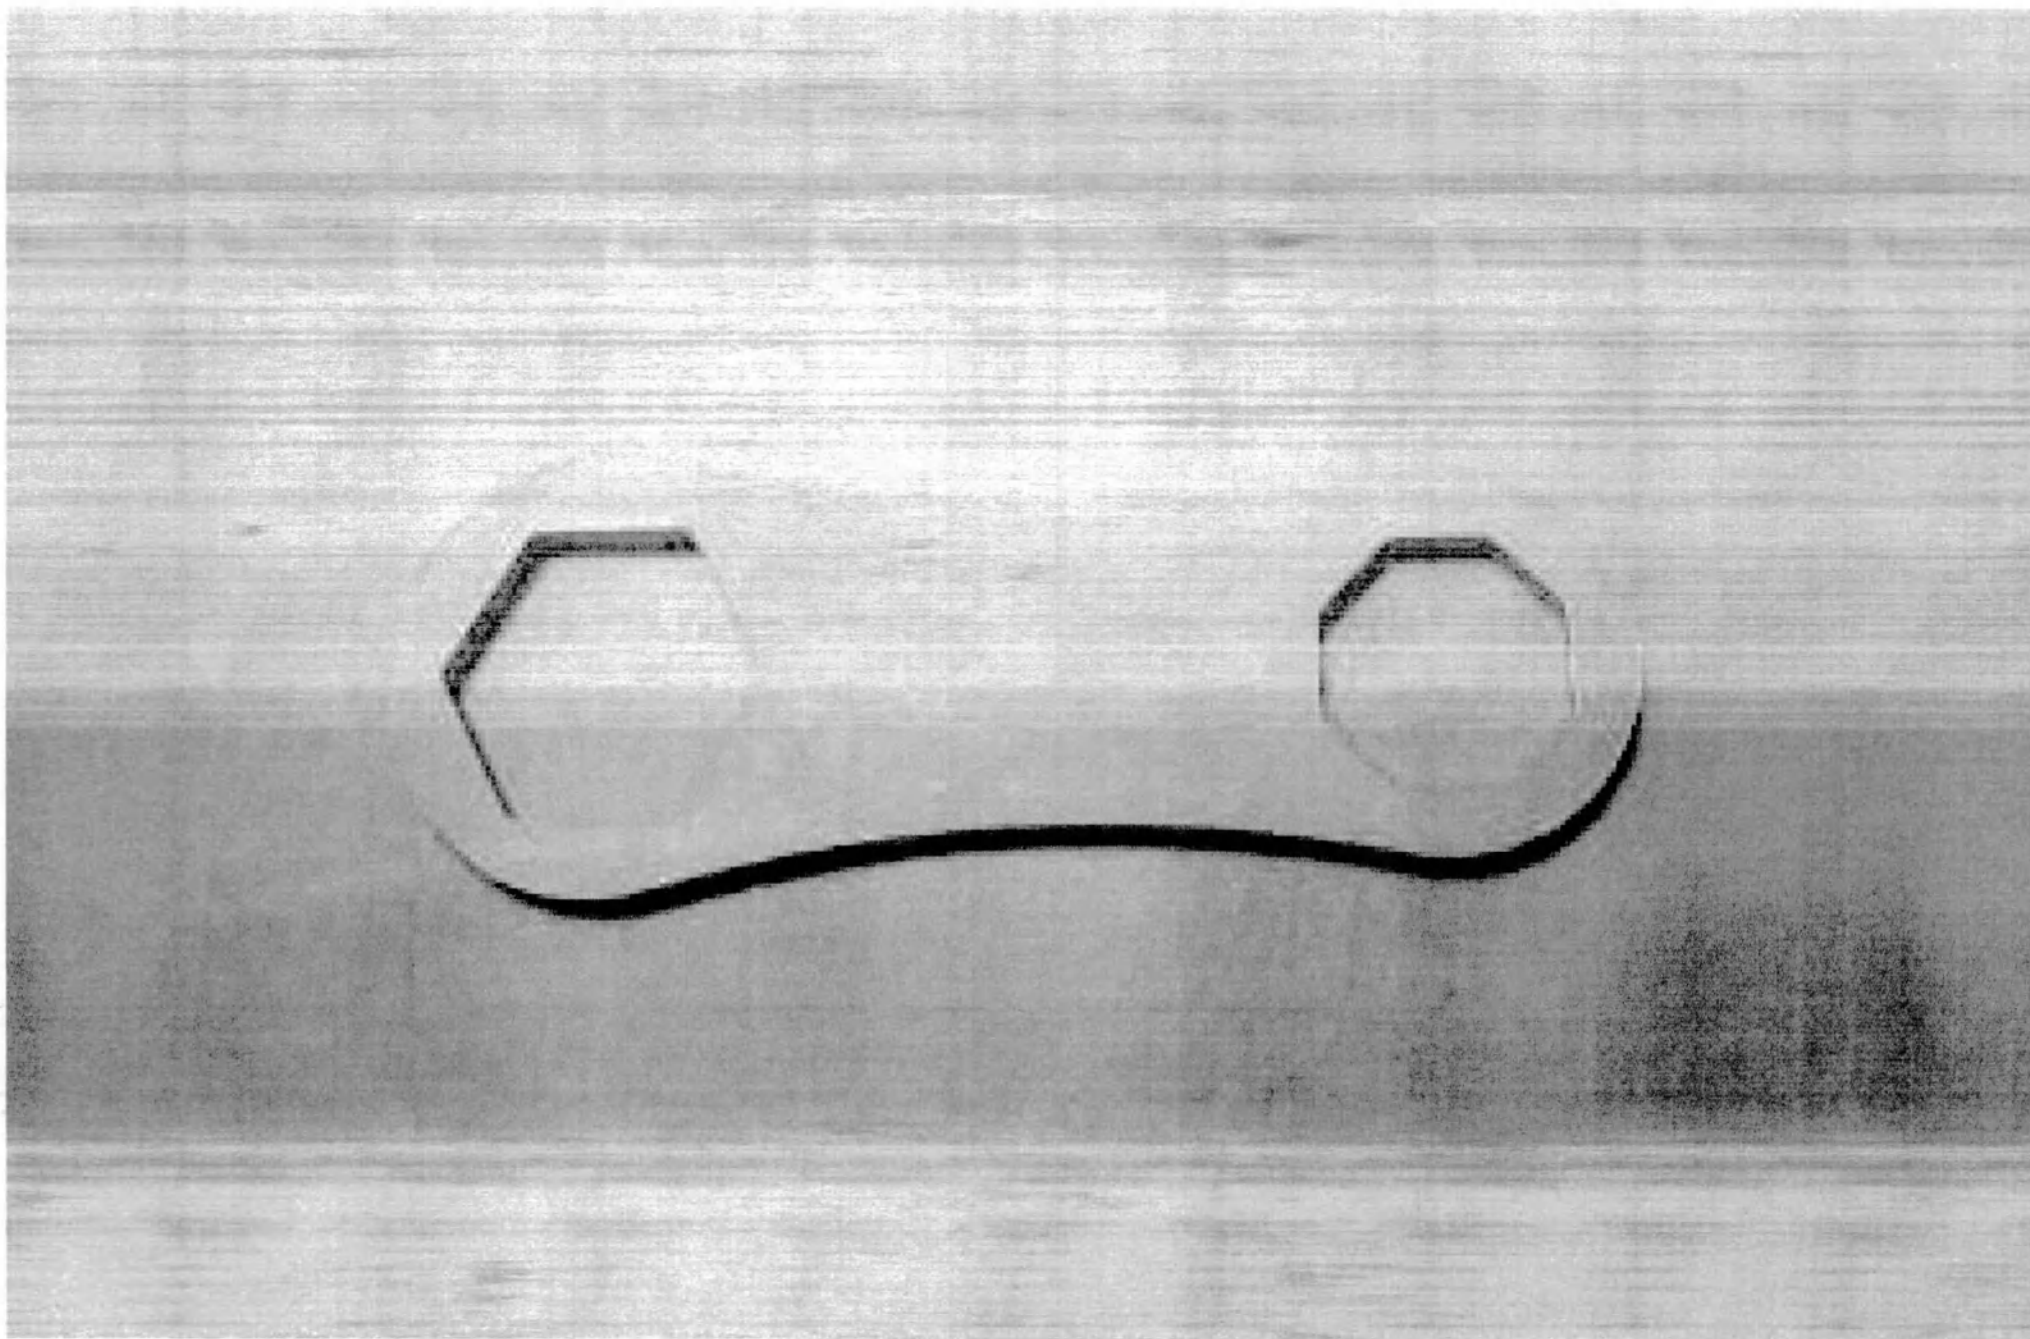

Фотографическое изображение 19 – Ключ для разборки наконечника



Фотографическое изображение 20 – Потребительская упаковка

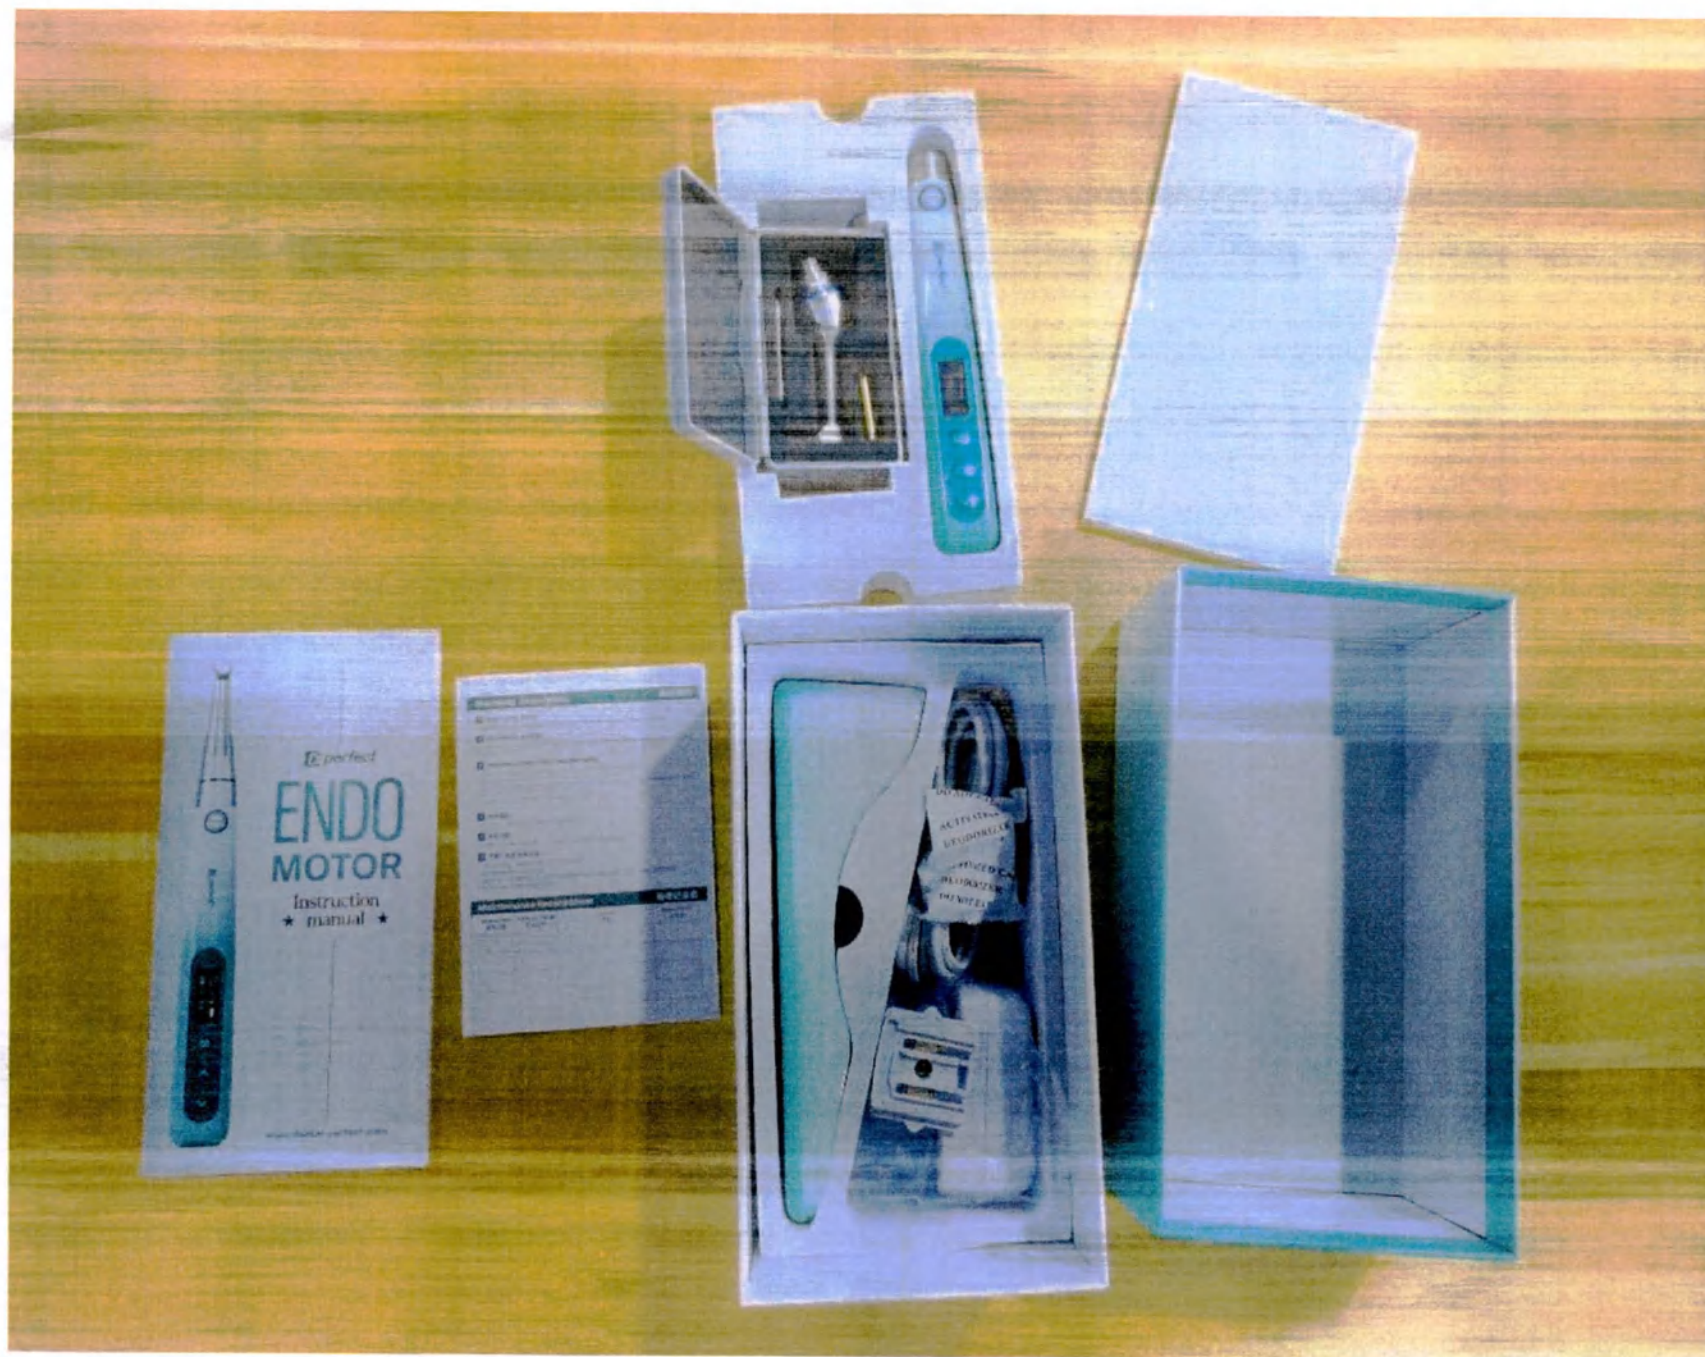

Фотографическое изображение 21 – Потребительская упаковка




Фотографическое изображение 22 – Транспортная упаковка




Фотографическое изображение 23 – Транспортная упаковка

2. Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором, модель ZR Rap

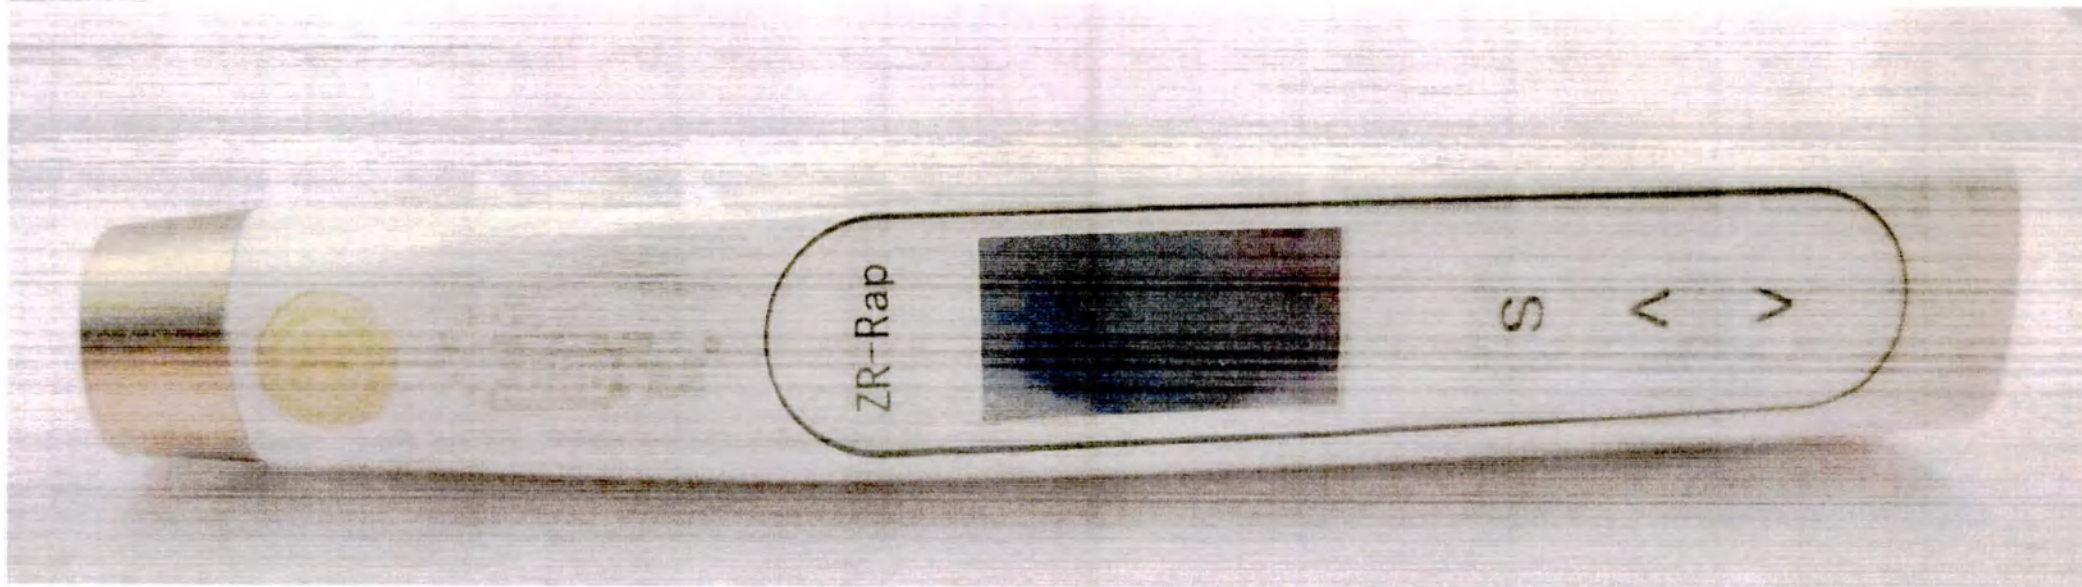


Фотографическое изображение 24 – Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором, модель ZR Rap (вид спереди)

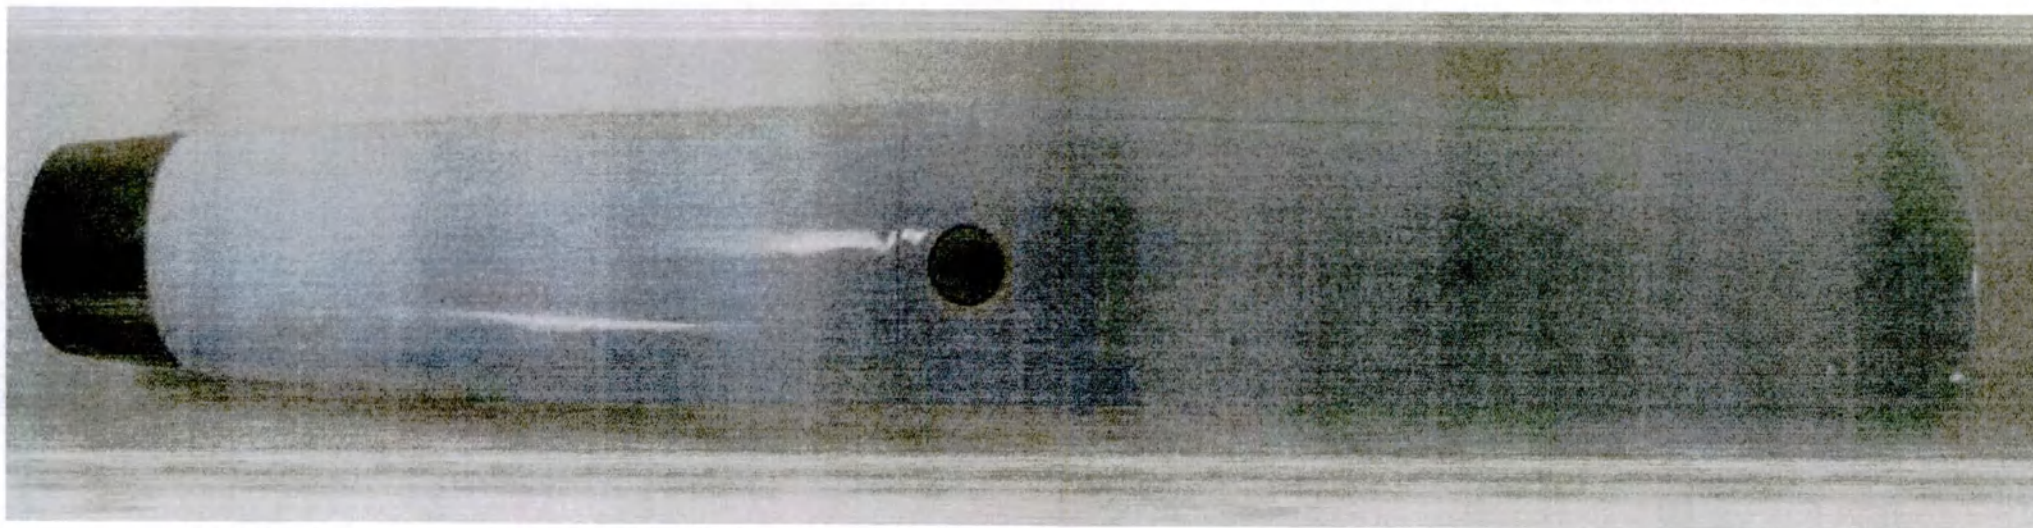


Фотографическое изображение 25 – Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором, модель ZR Rap (вид сзади)



Фотографическое изображение 26 – Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором, модель ZR Rap (вид сбоку)

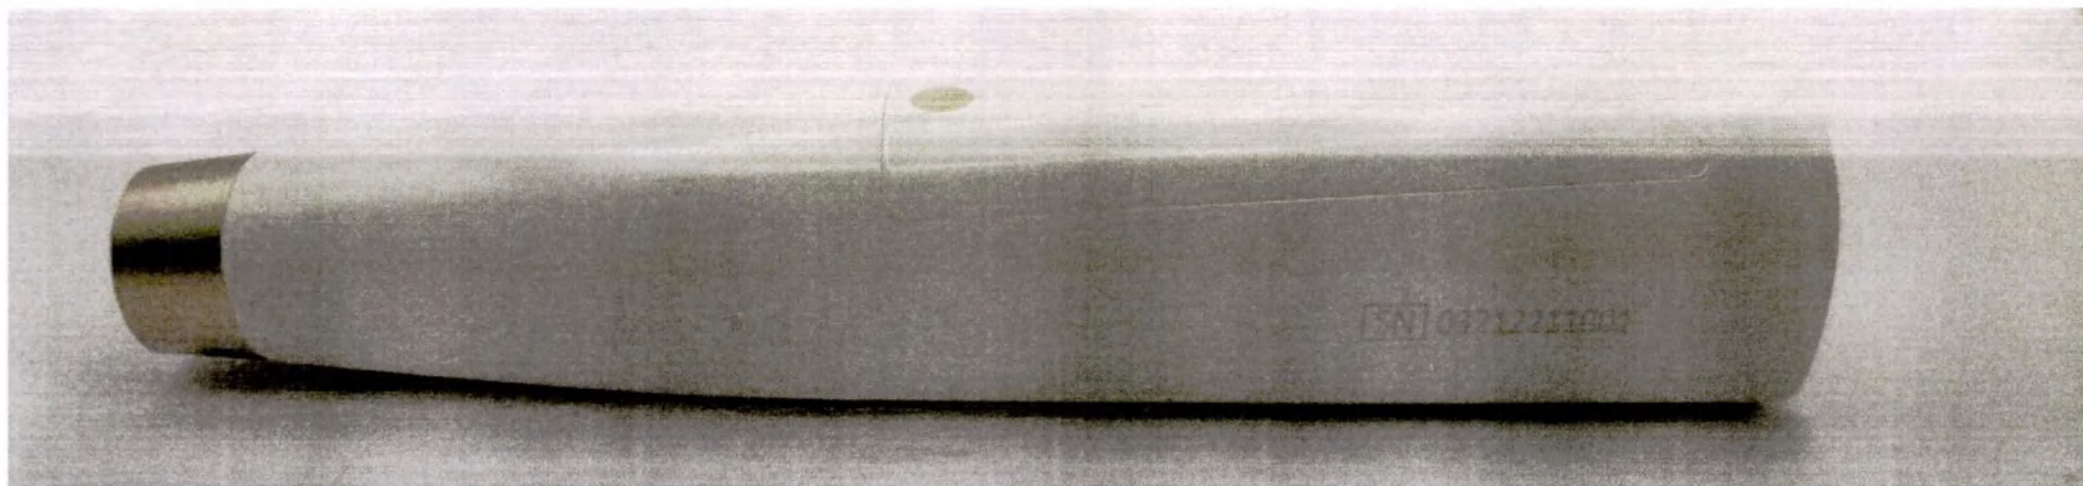


Фотографическое изображение 27 – Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором, модель ZR Rap (вид сбоку)

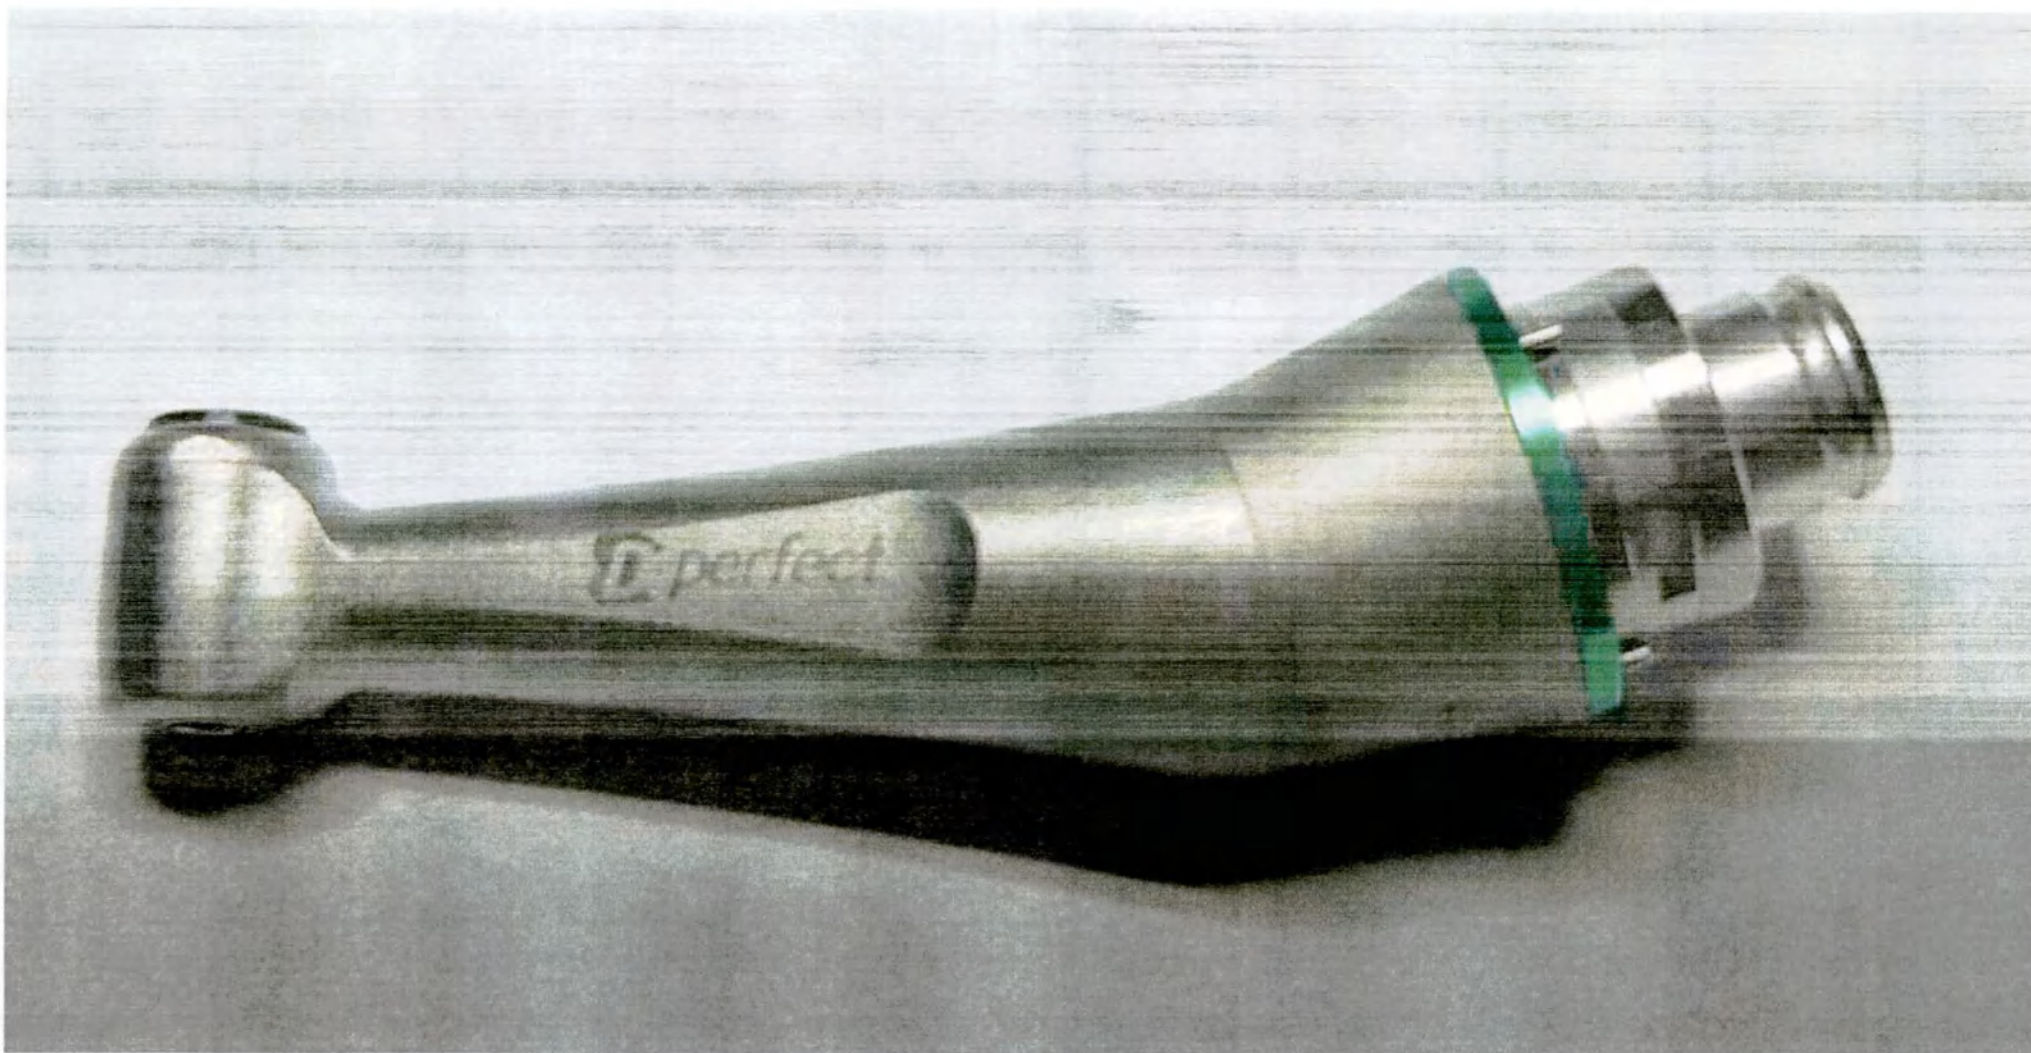


Фотографическое изображение 28 – Контругловой наконечник, модель E-X61CA-A




Фотографическое изображение 29 – Контругловой наконечник, модель E-X61CA-A (вид сбоку)

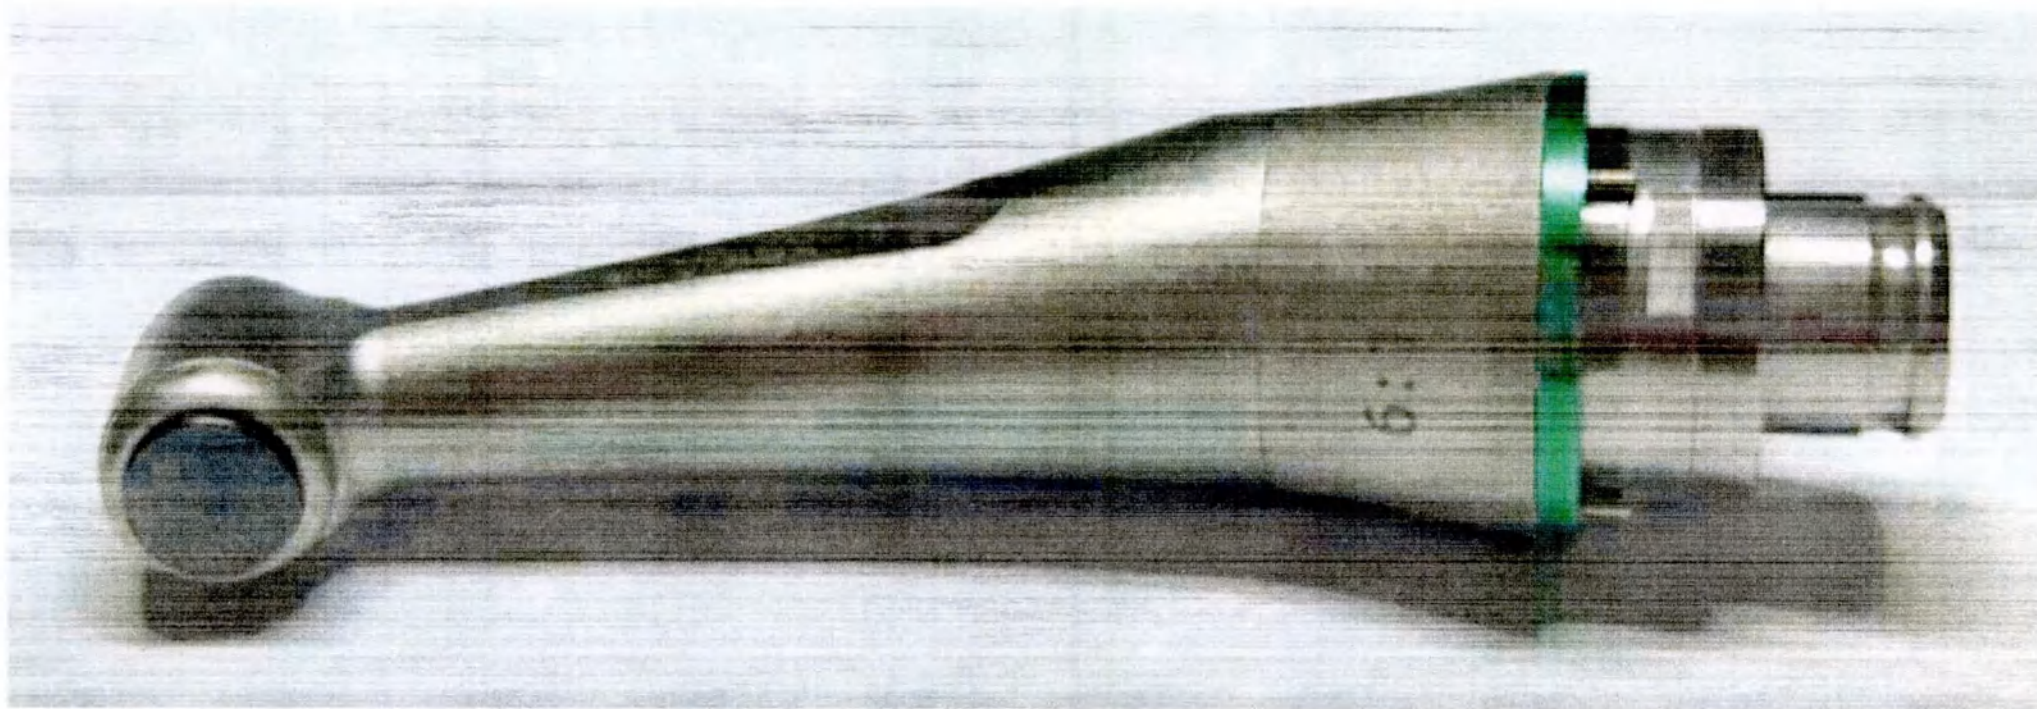


Фотографическое изображение 30 – Контругловый наконечник, модель E-X61CA-A (вид спереди)

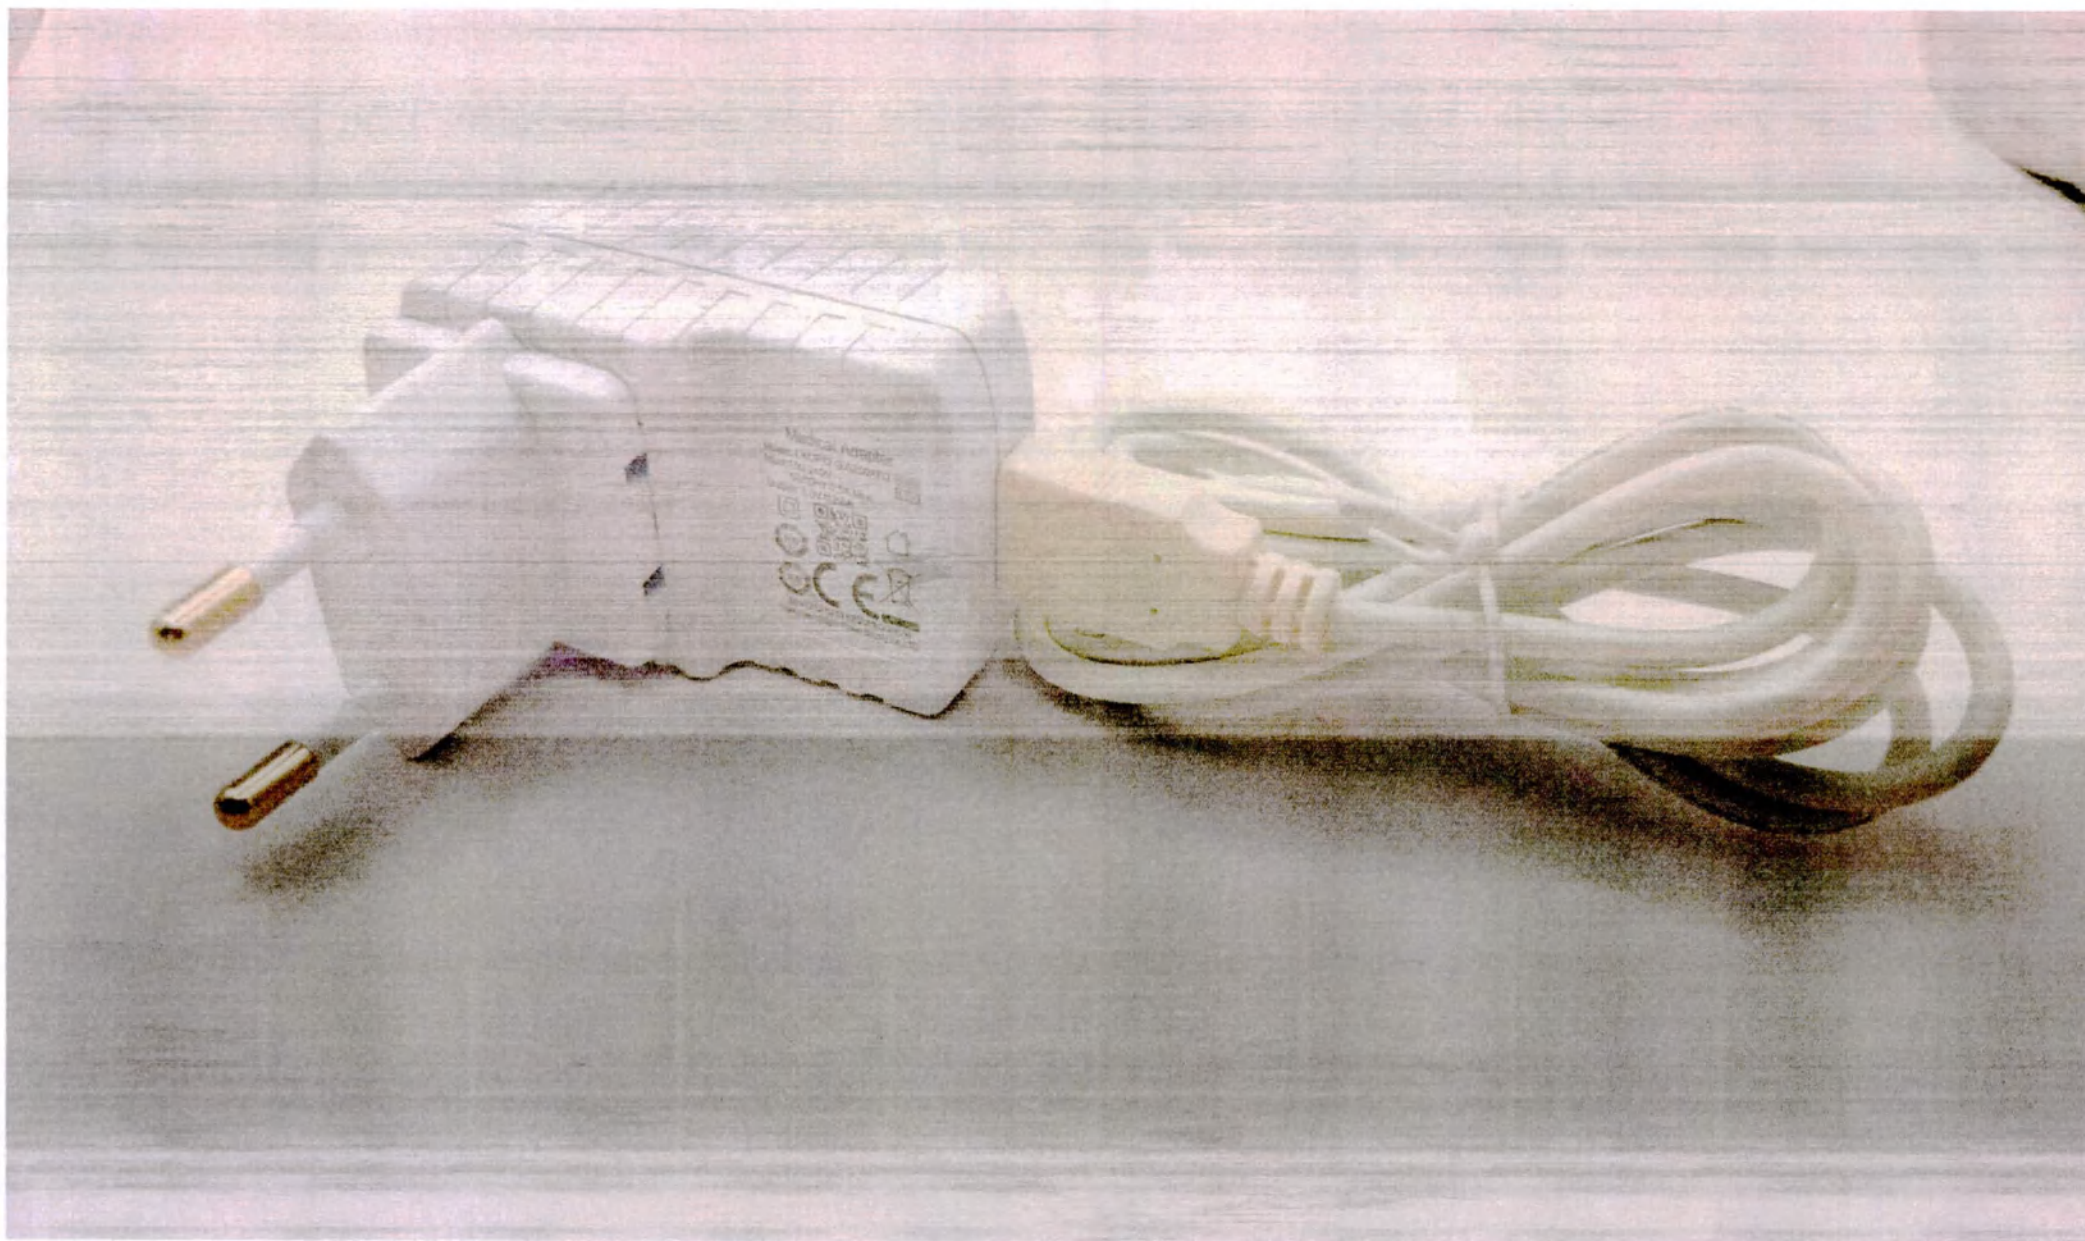


Фотографическое изображение 31 – Адаптер питания в составе

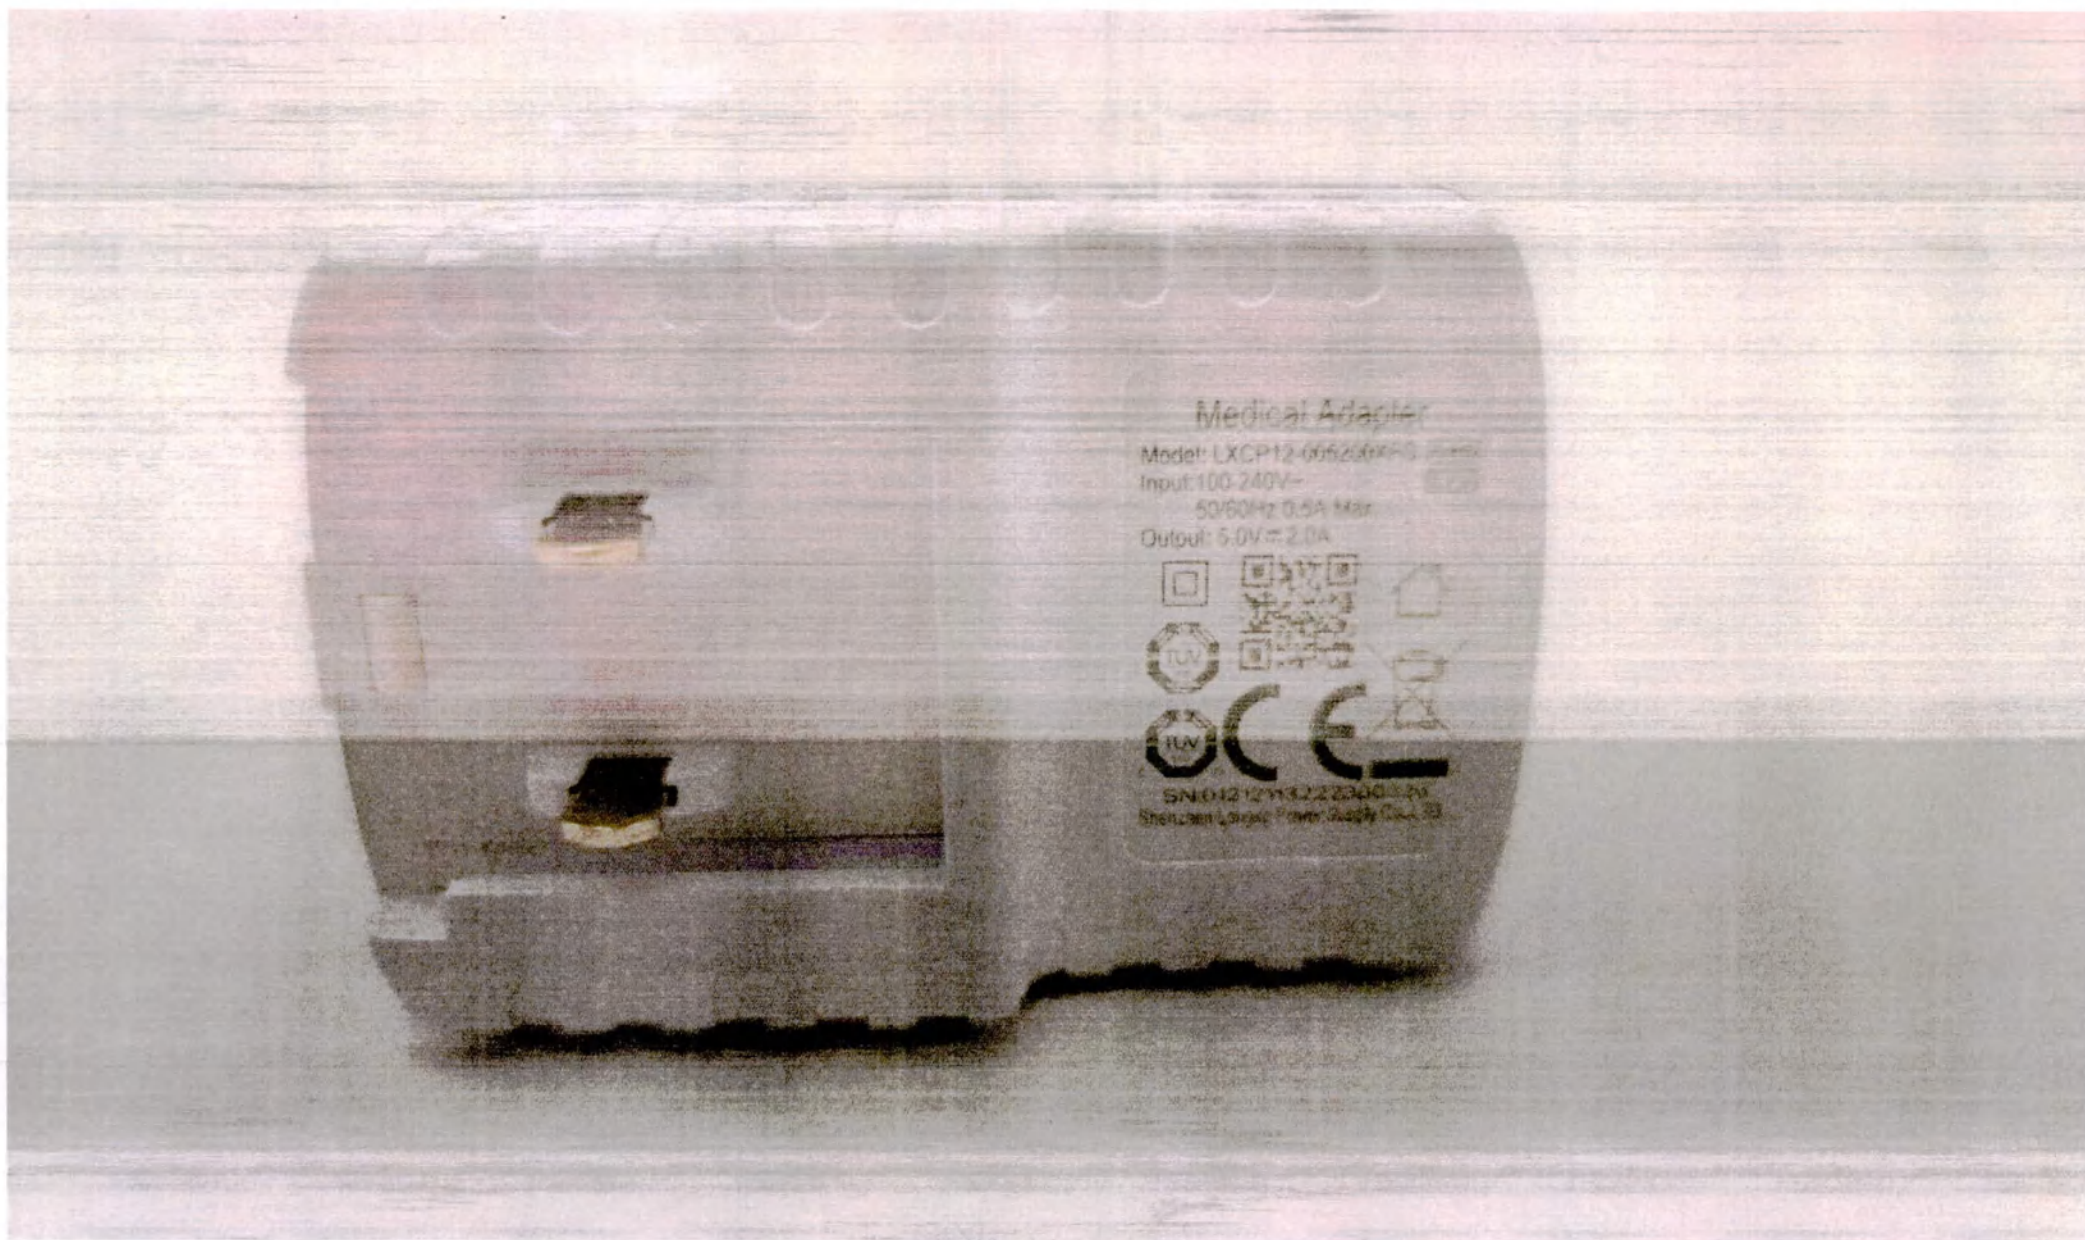

Фотографическое изображение 32 – Адаптер питания

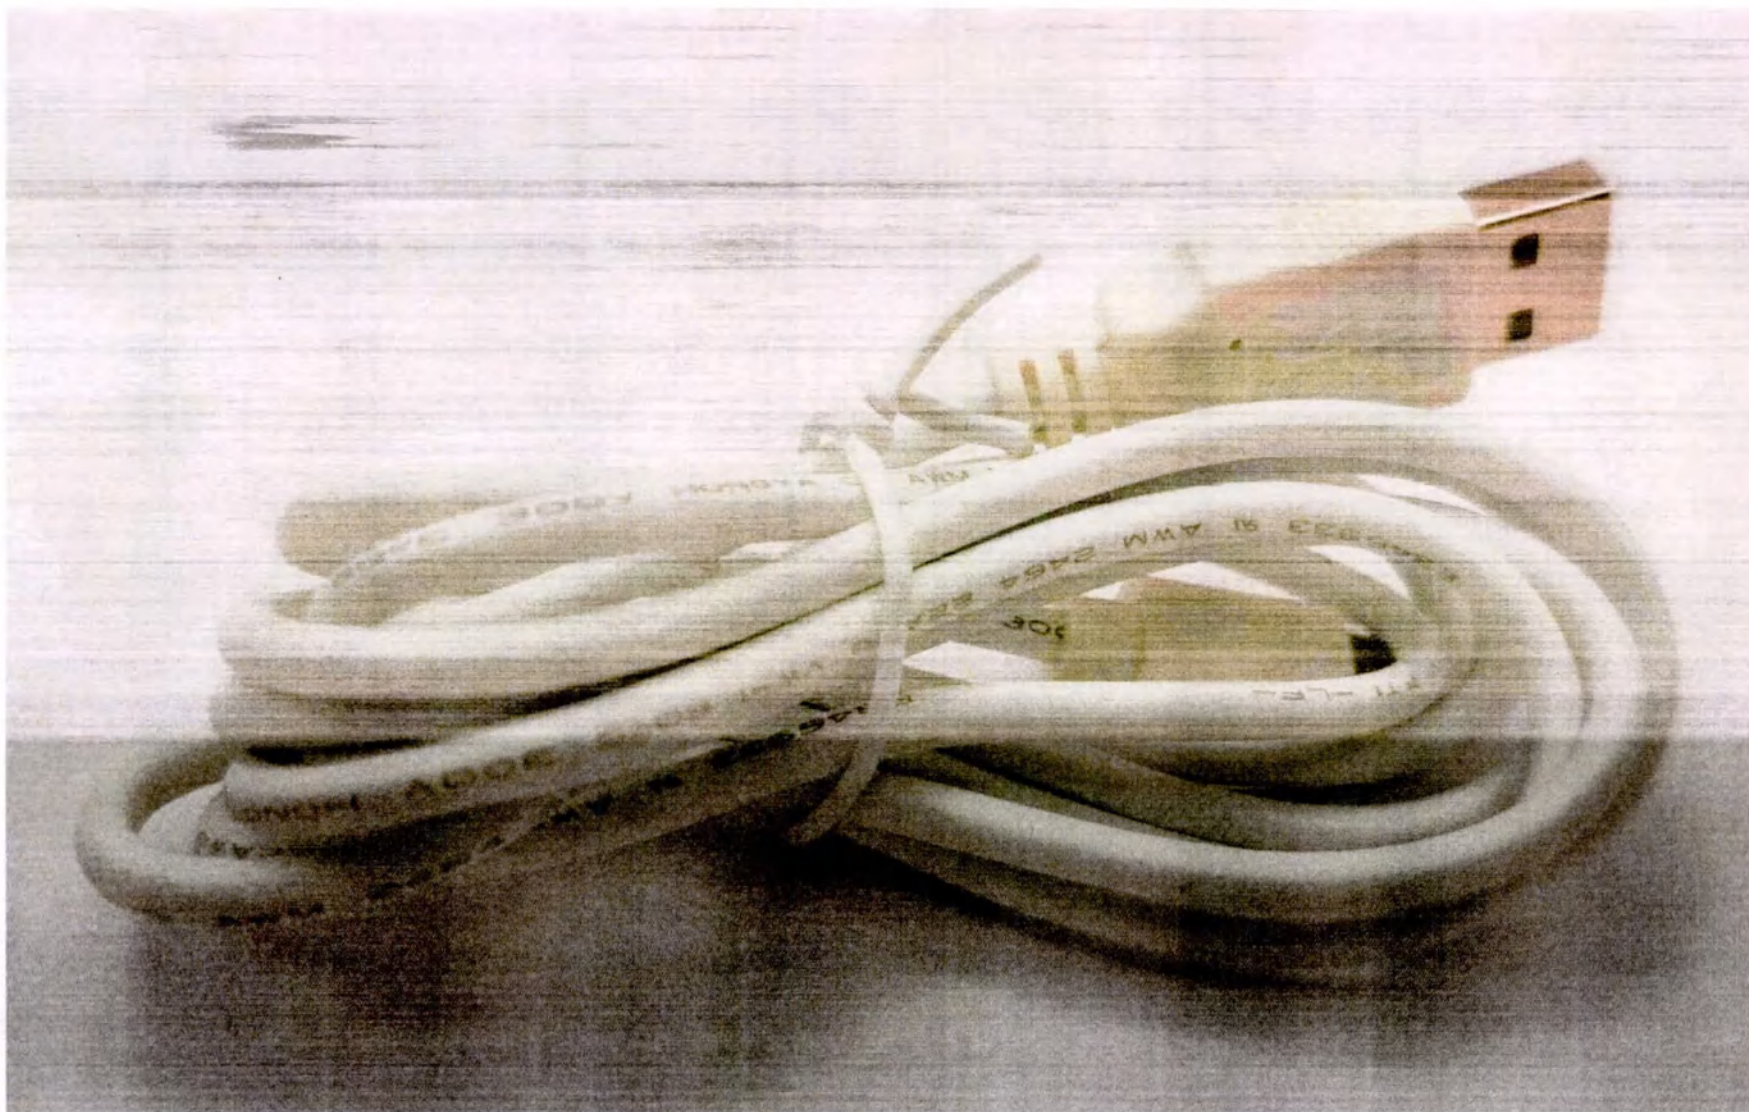


Фотографическое изображение 33 – Кабель питания

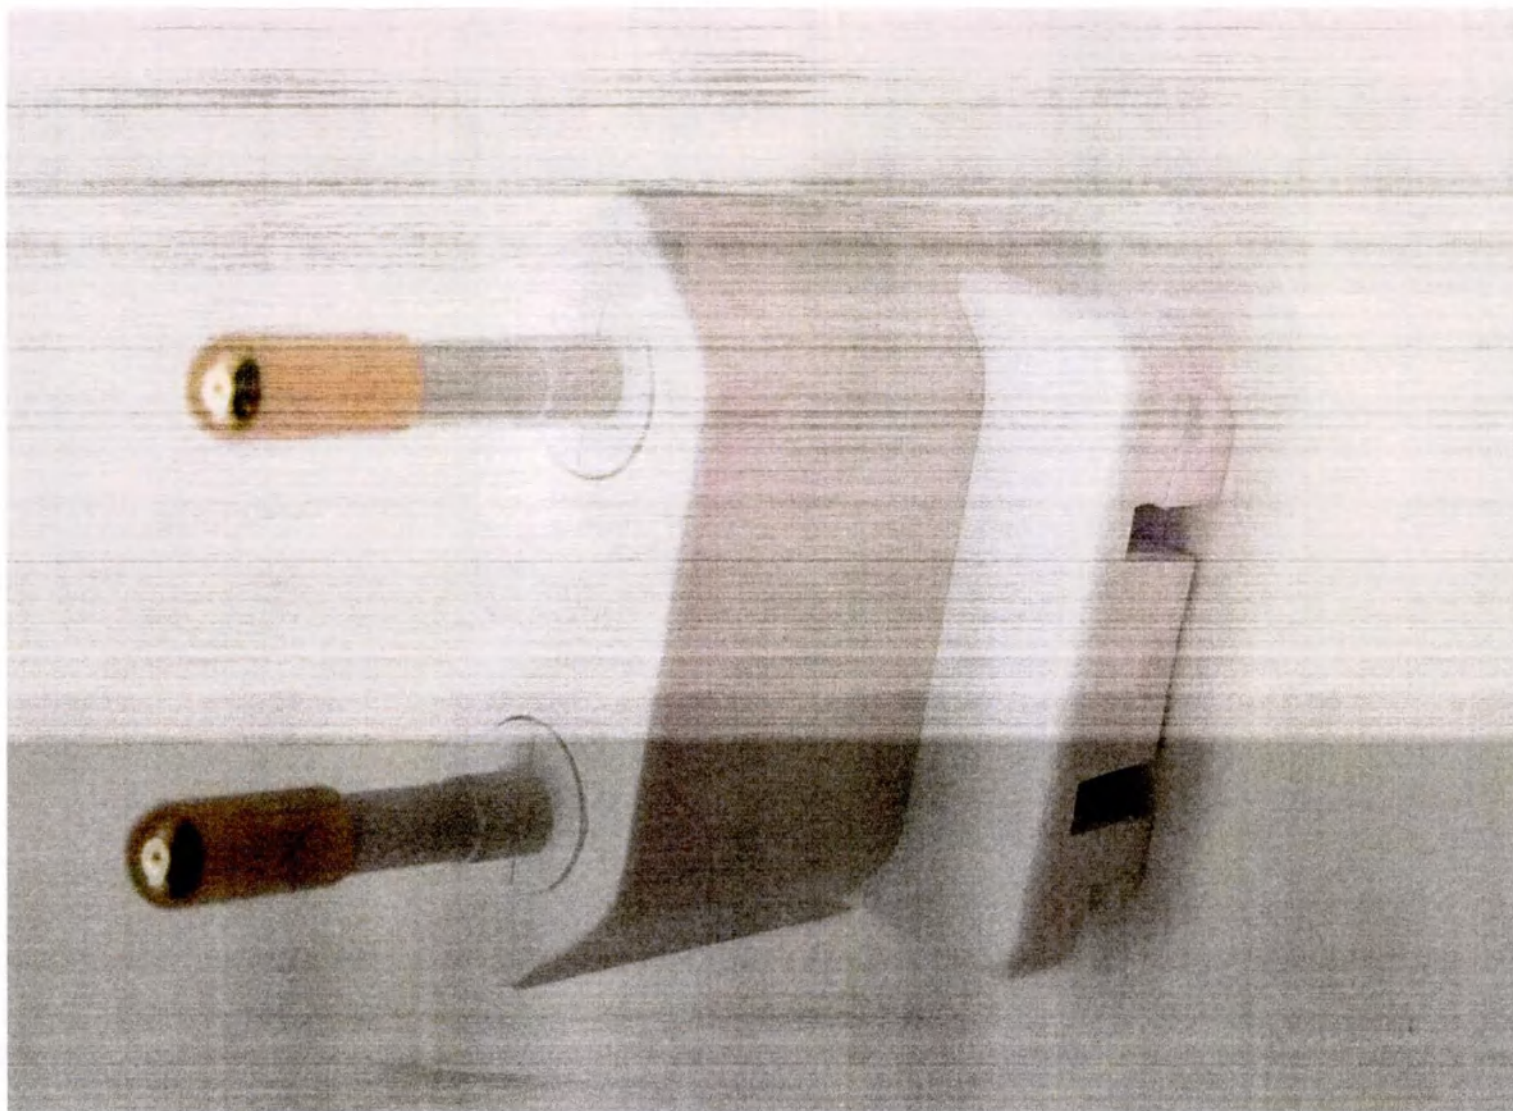

Фотографическое изображение 34 – Переходник для адаптера питания




Фотографическое изображение 35 – Подставка с эндомотором (общий вид)

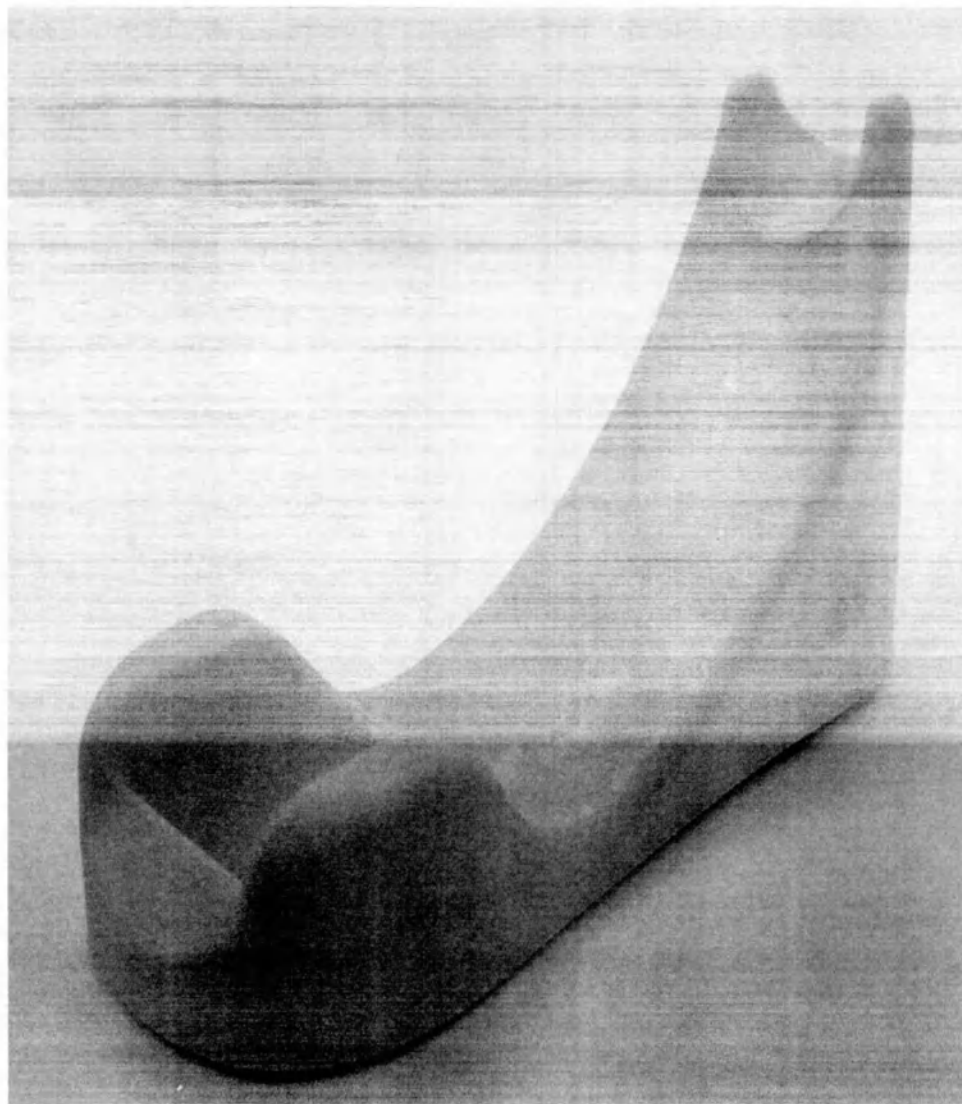


Фотографическое изображение 36 – Подставка (общий вид)




Фотографическое изображение 37 – Подставка (вид сверху)

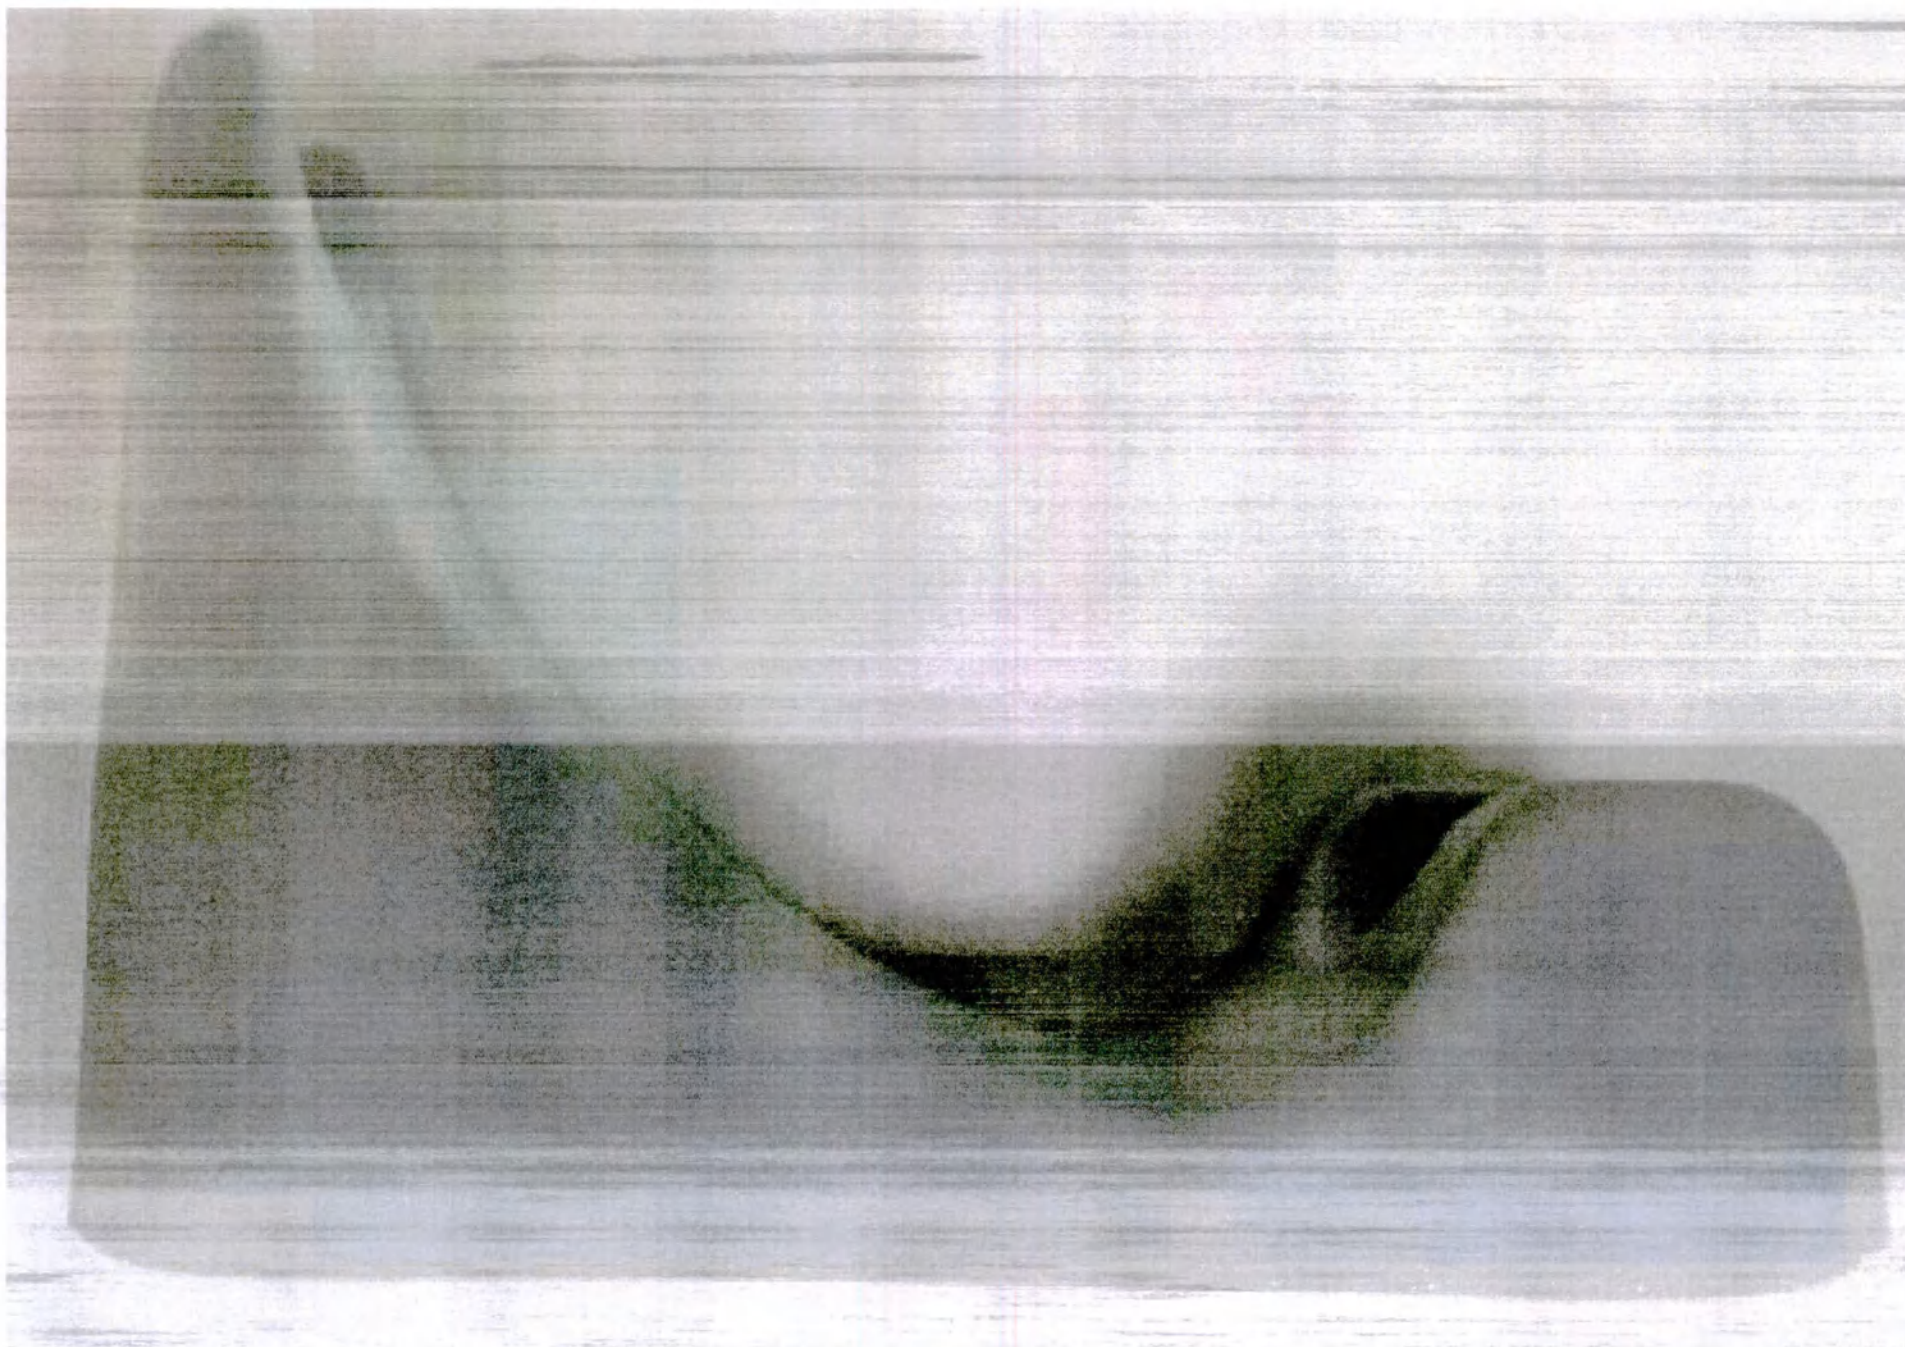


Фотографическое изображение 38 – Подставка (вид сбоку)

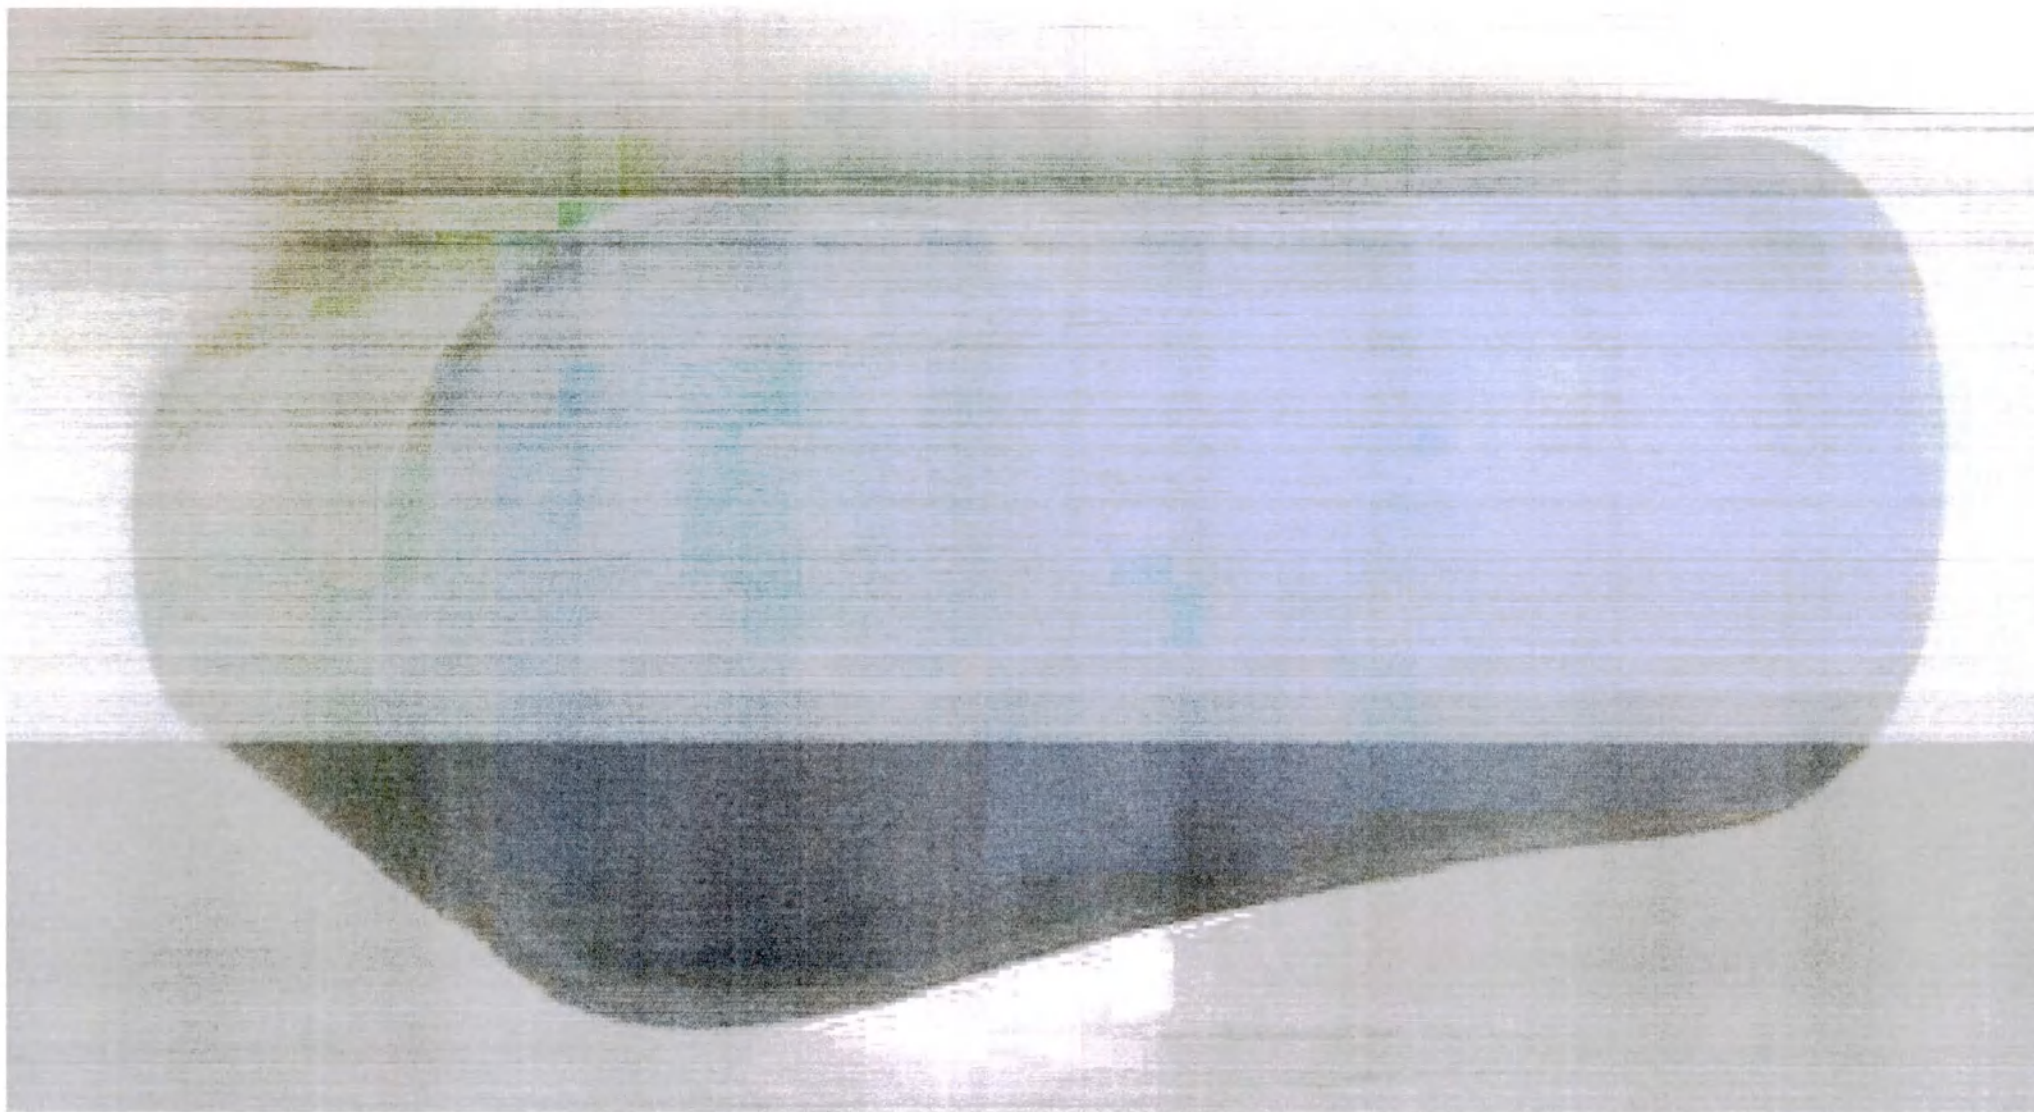


Фотографическое изображение 39 – Подставка (вид снизу)

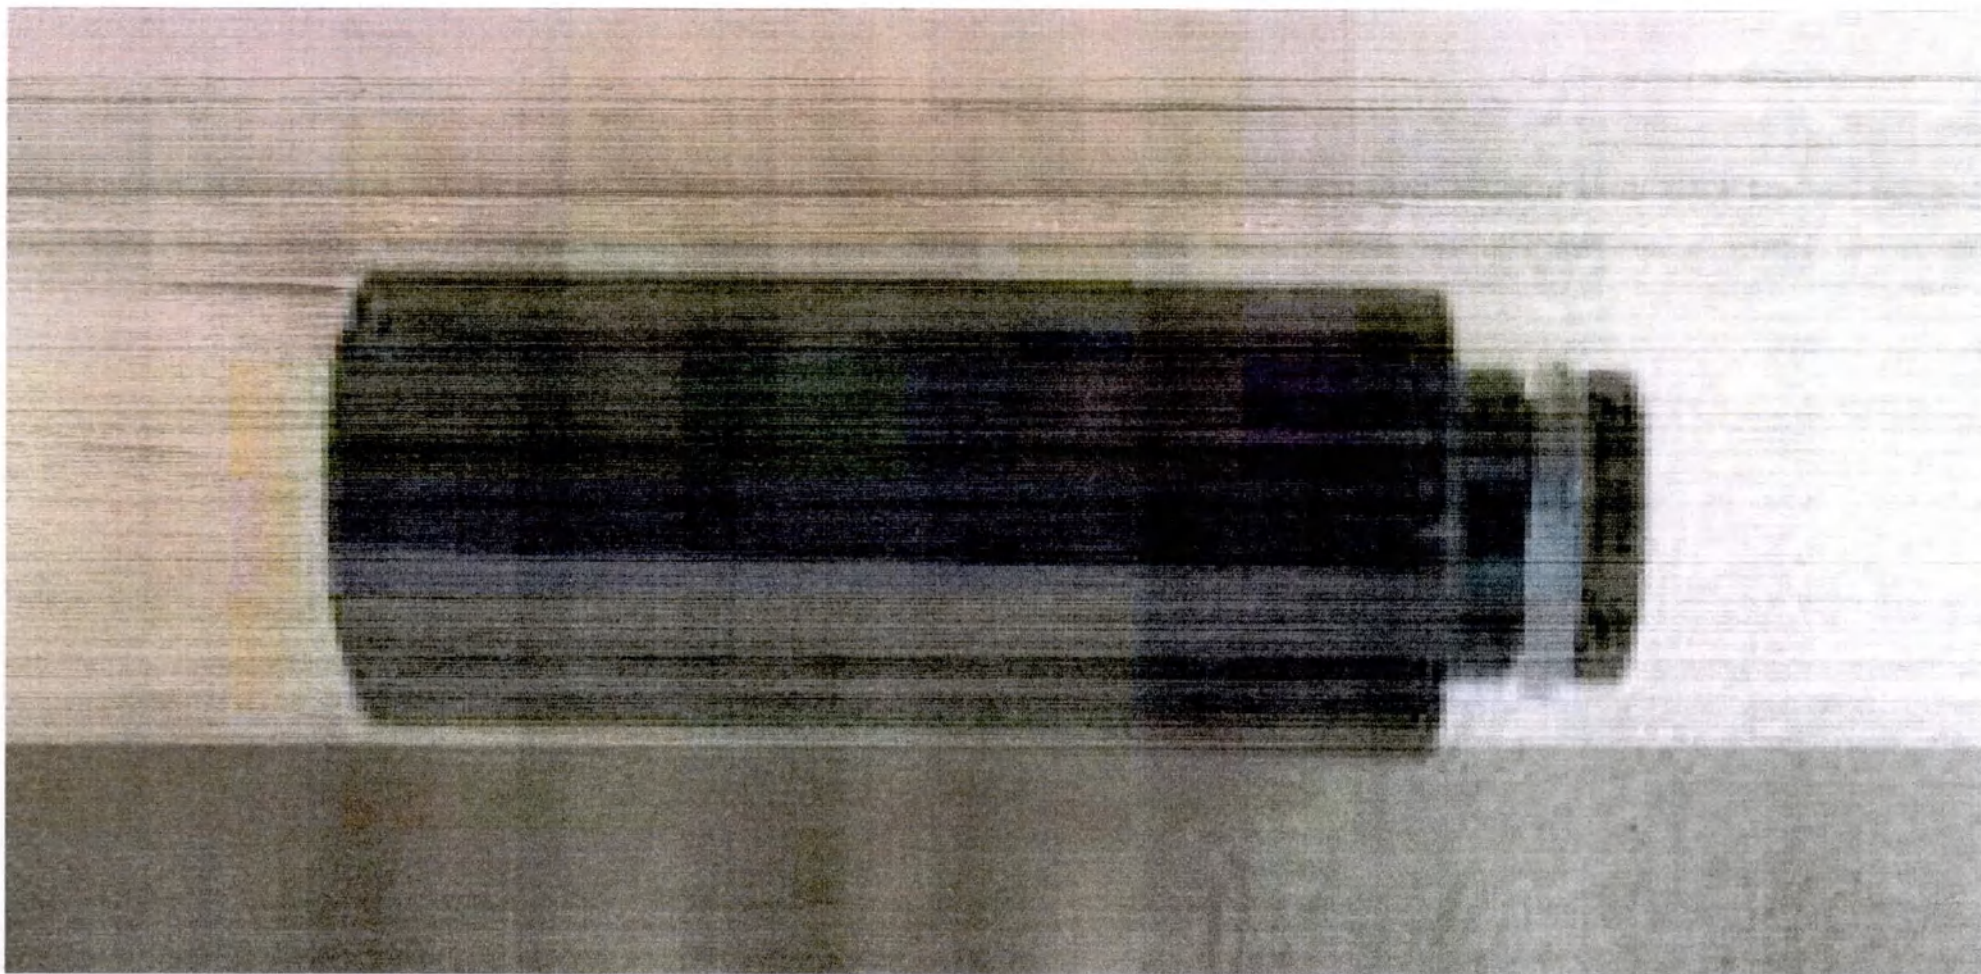


Фотографическое изображение 40 – Масляная форсунка

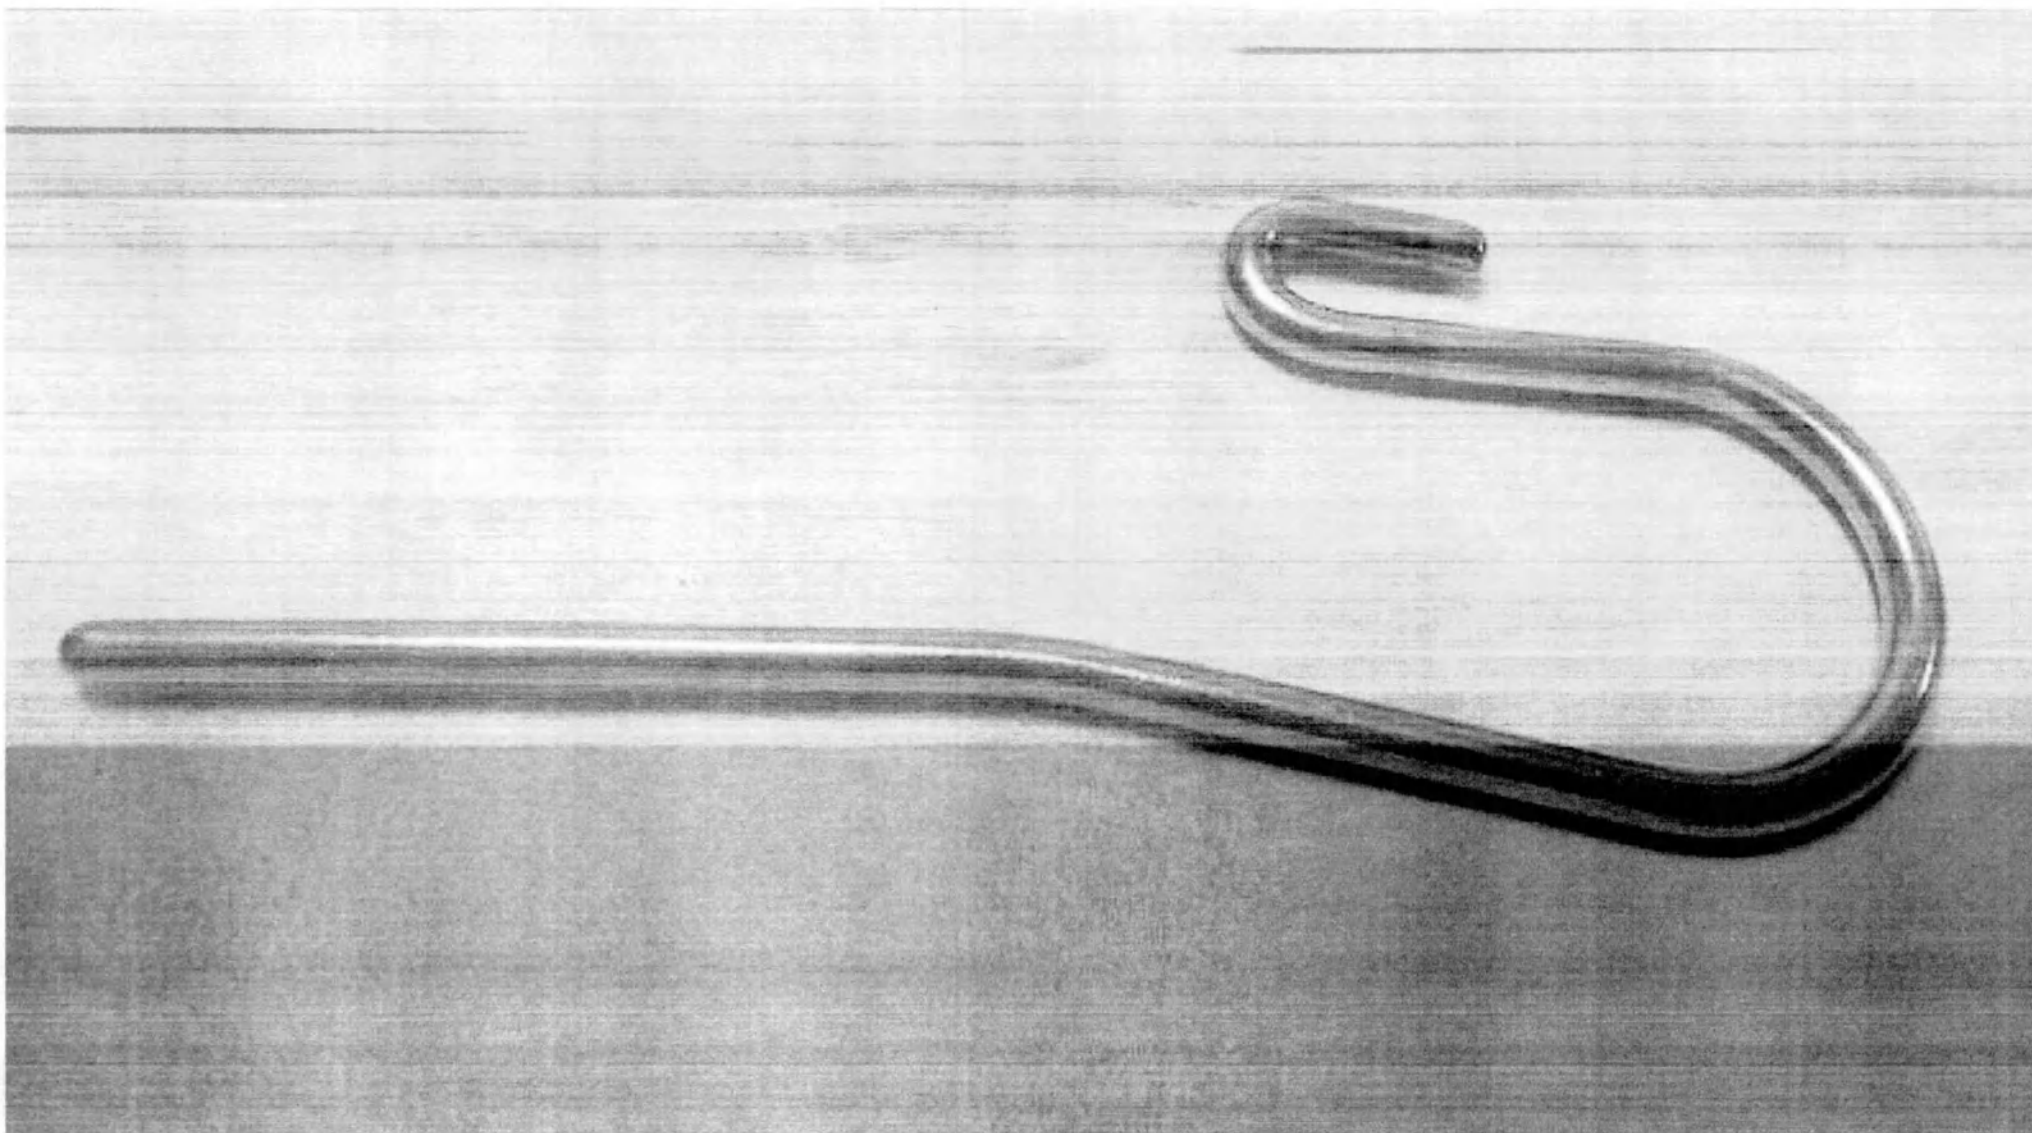


Фотографическое изображение 41 – Загубник

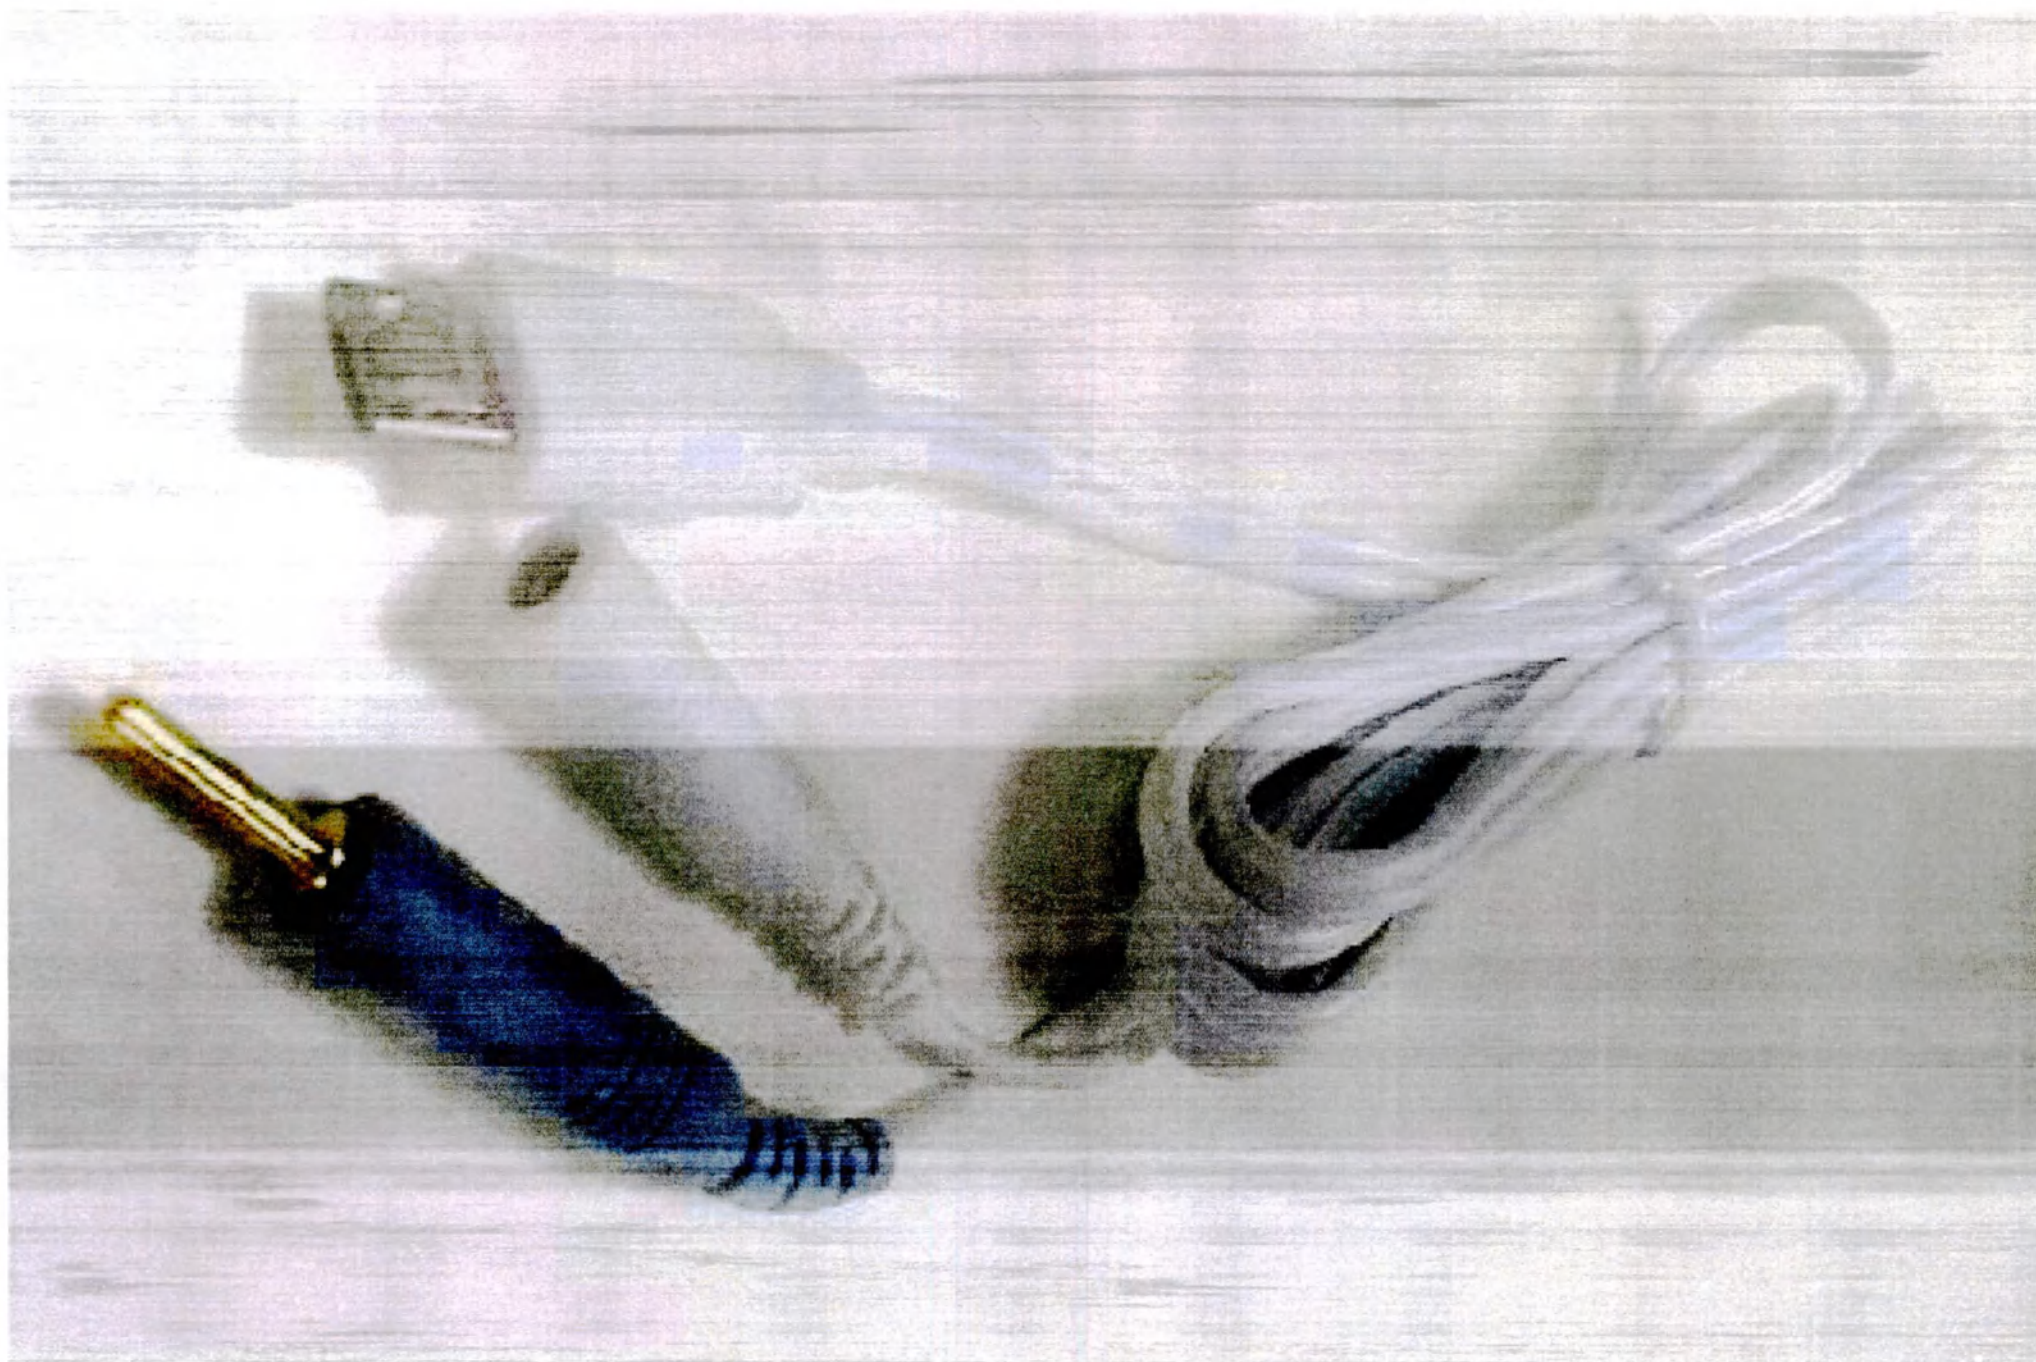


Фотографическое изображение 42 – Измерительный провод

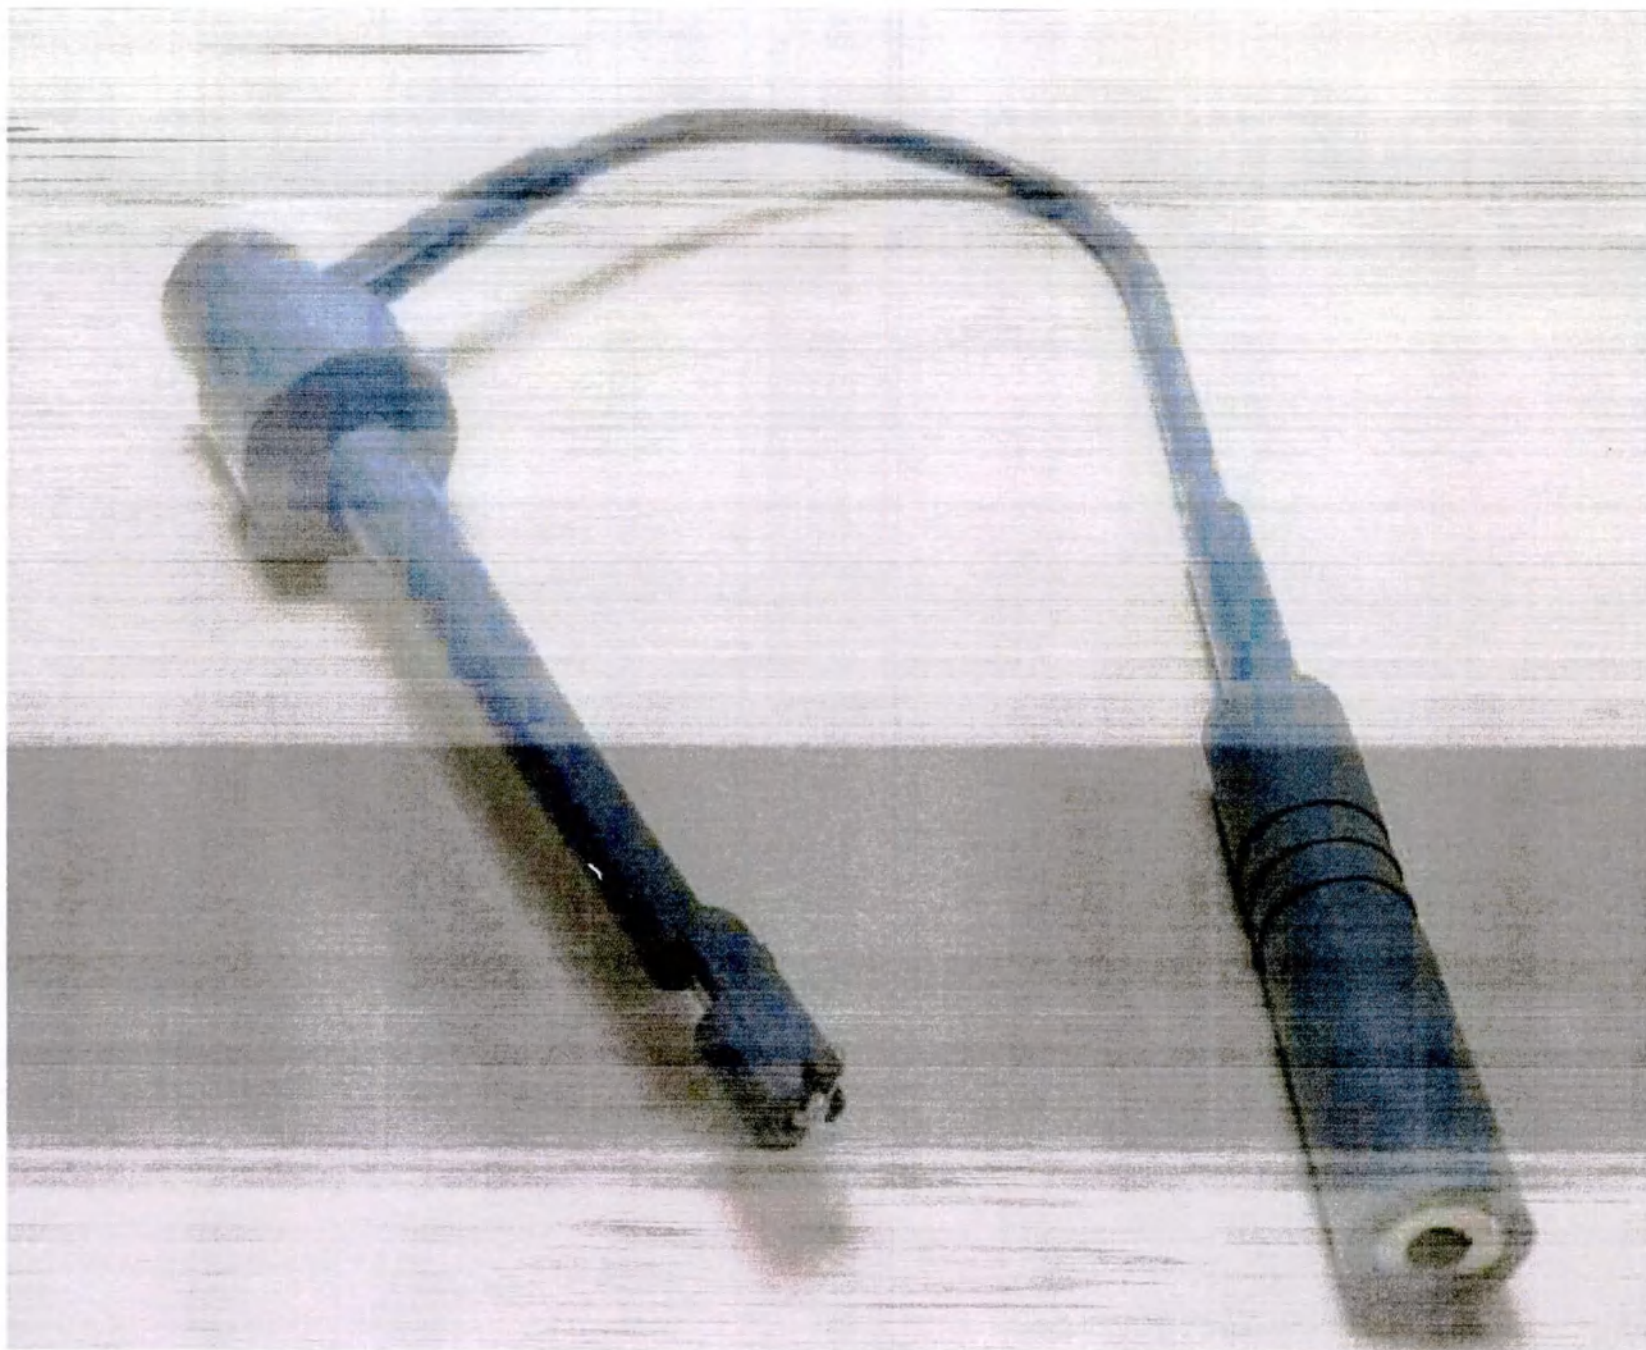


Фотографическое изображение 43 – Файл-кит

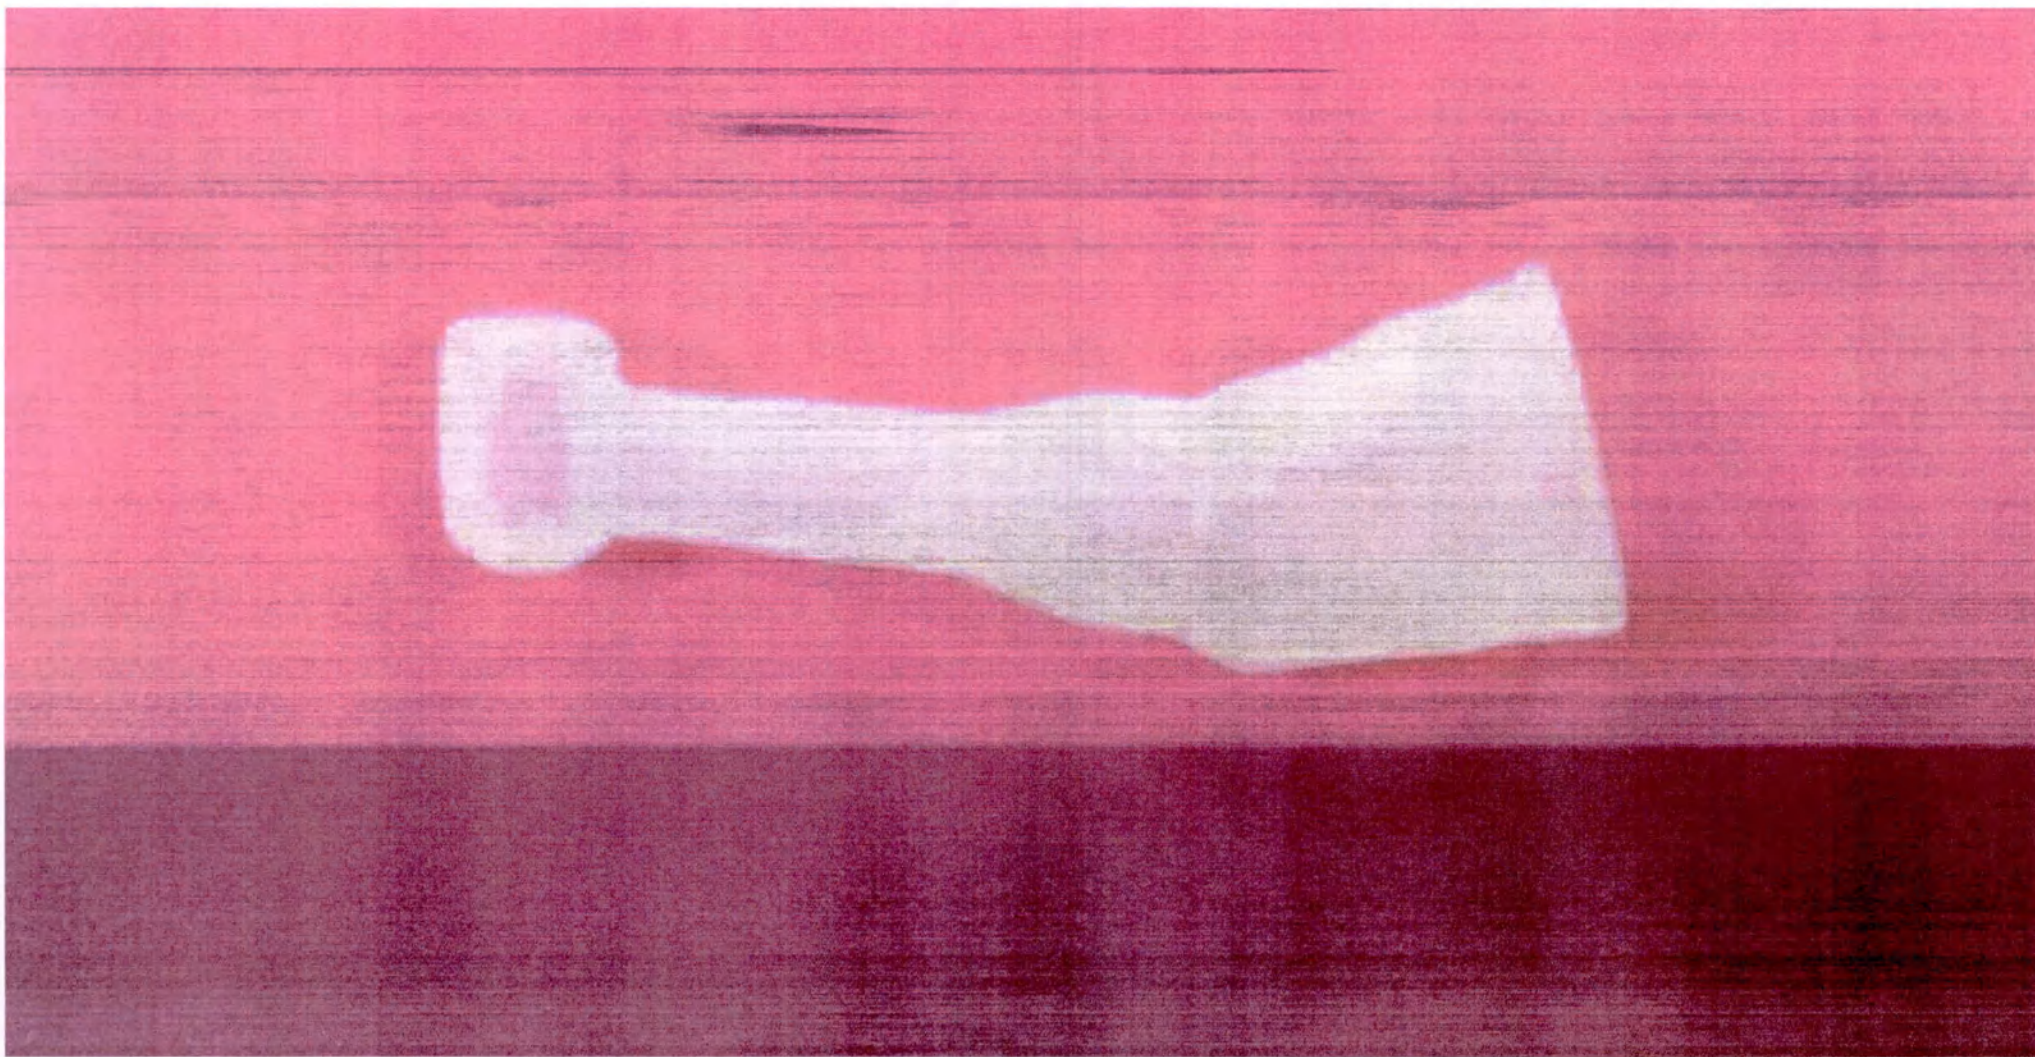


Фотографическое изображение 44 – Защитный силиконовый чехол

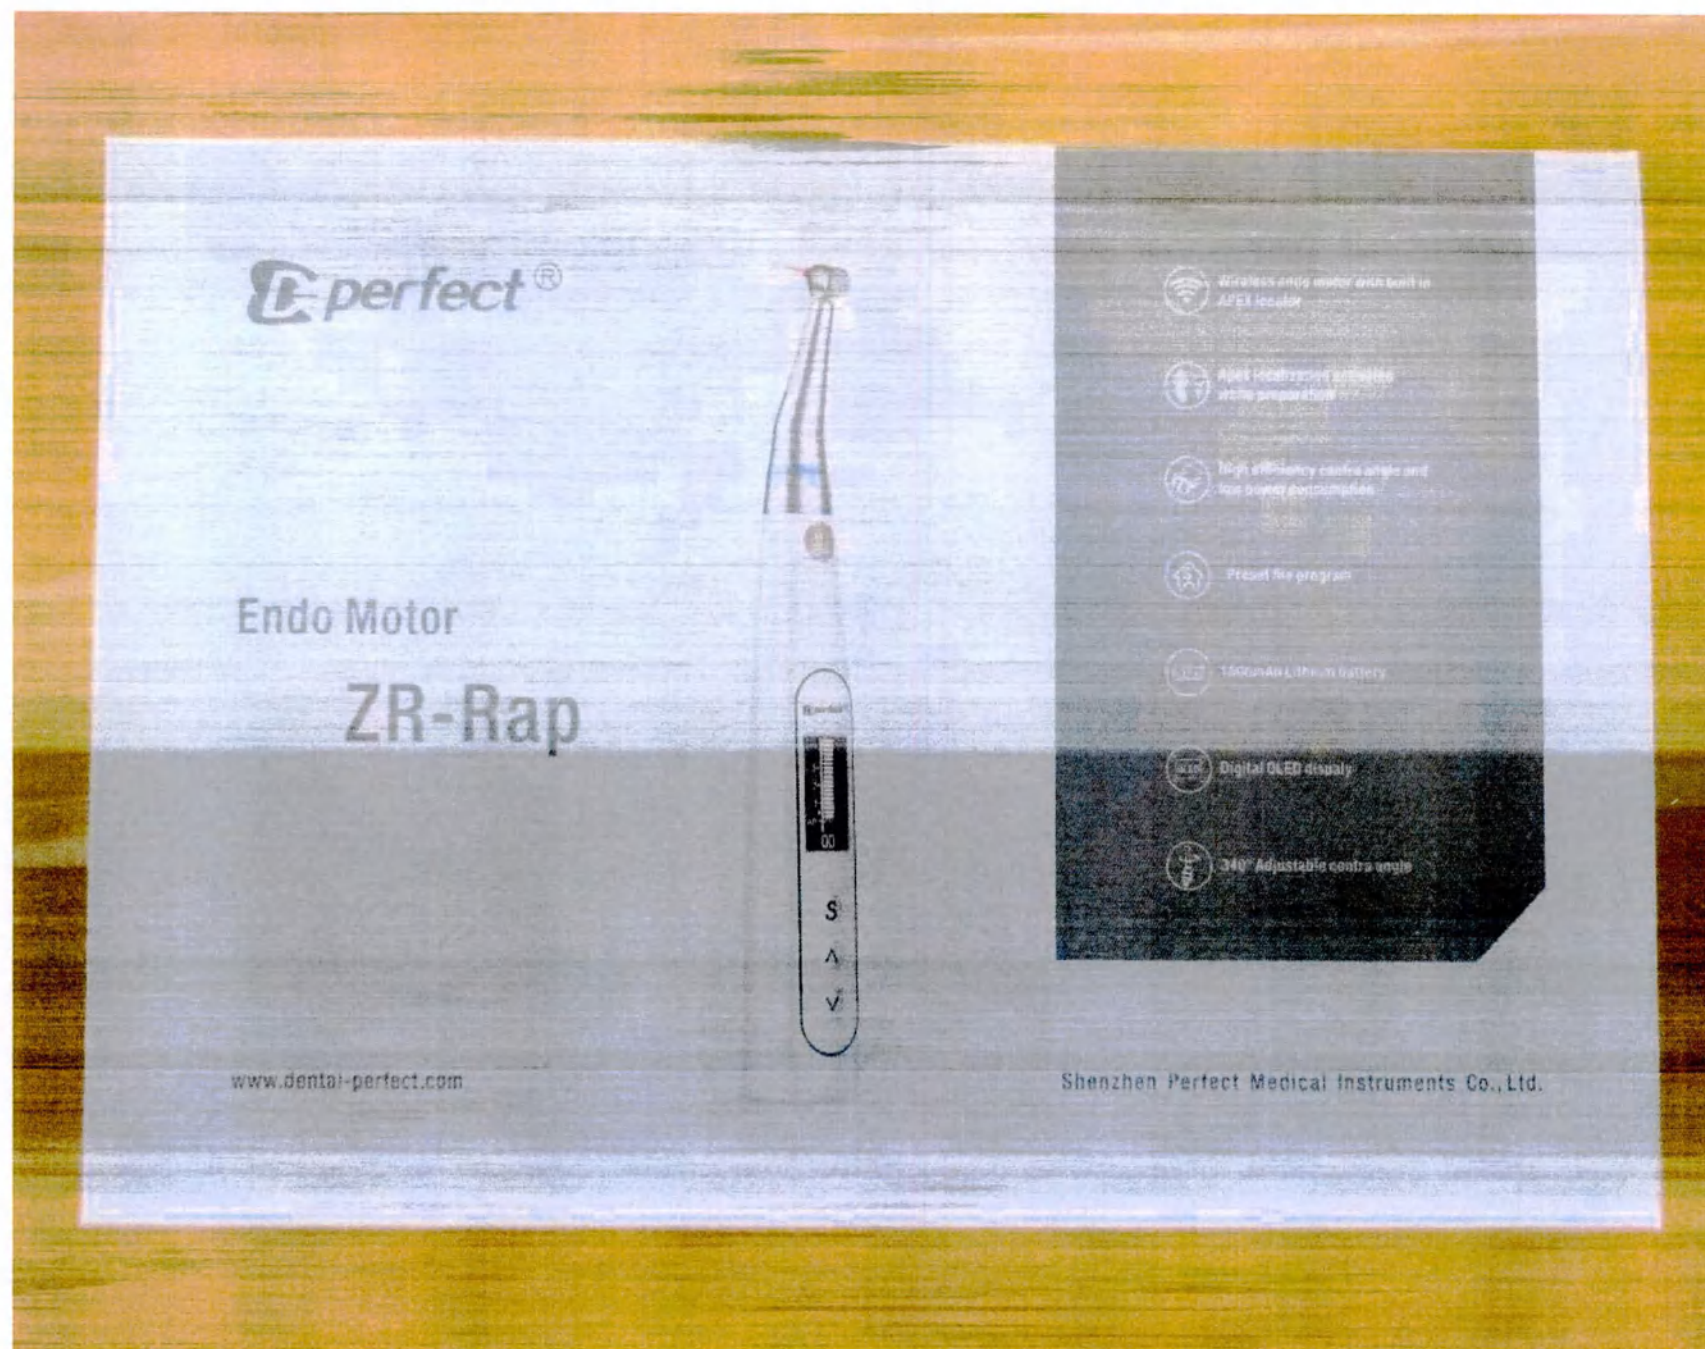


Фотографическое изображение 45 – Потребительская упаковка

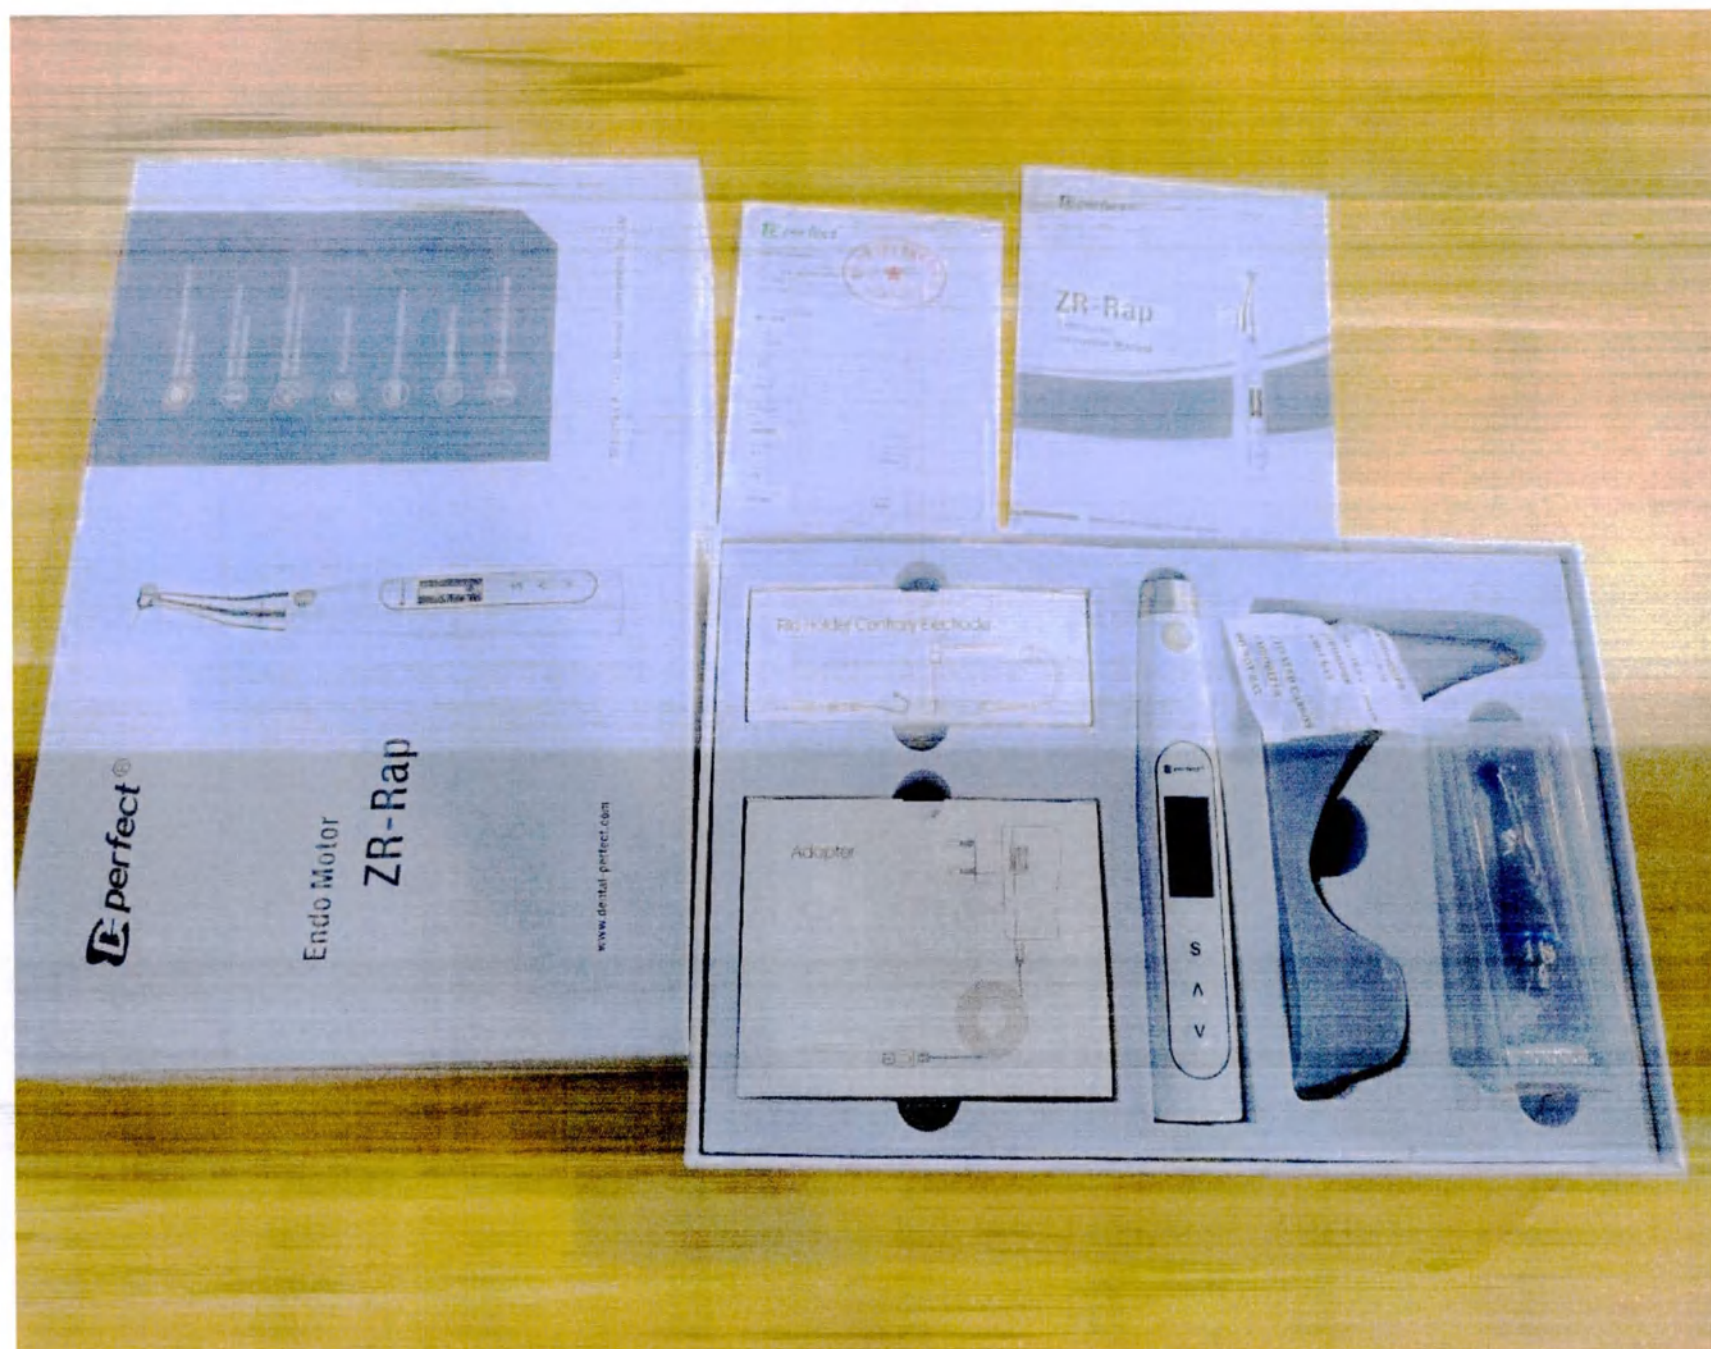


Фотографическое изображение 46 – Потребительская упаковка

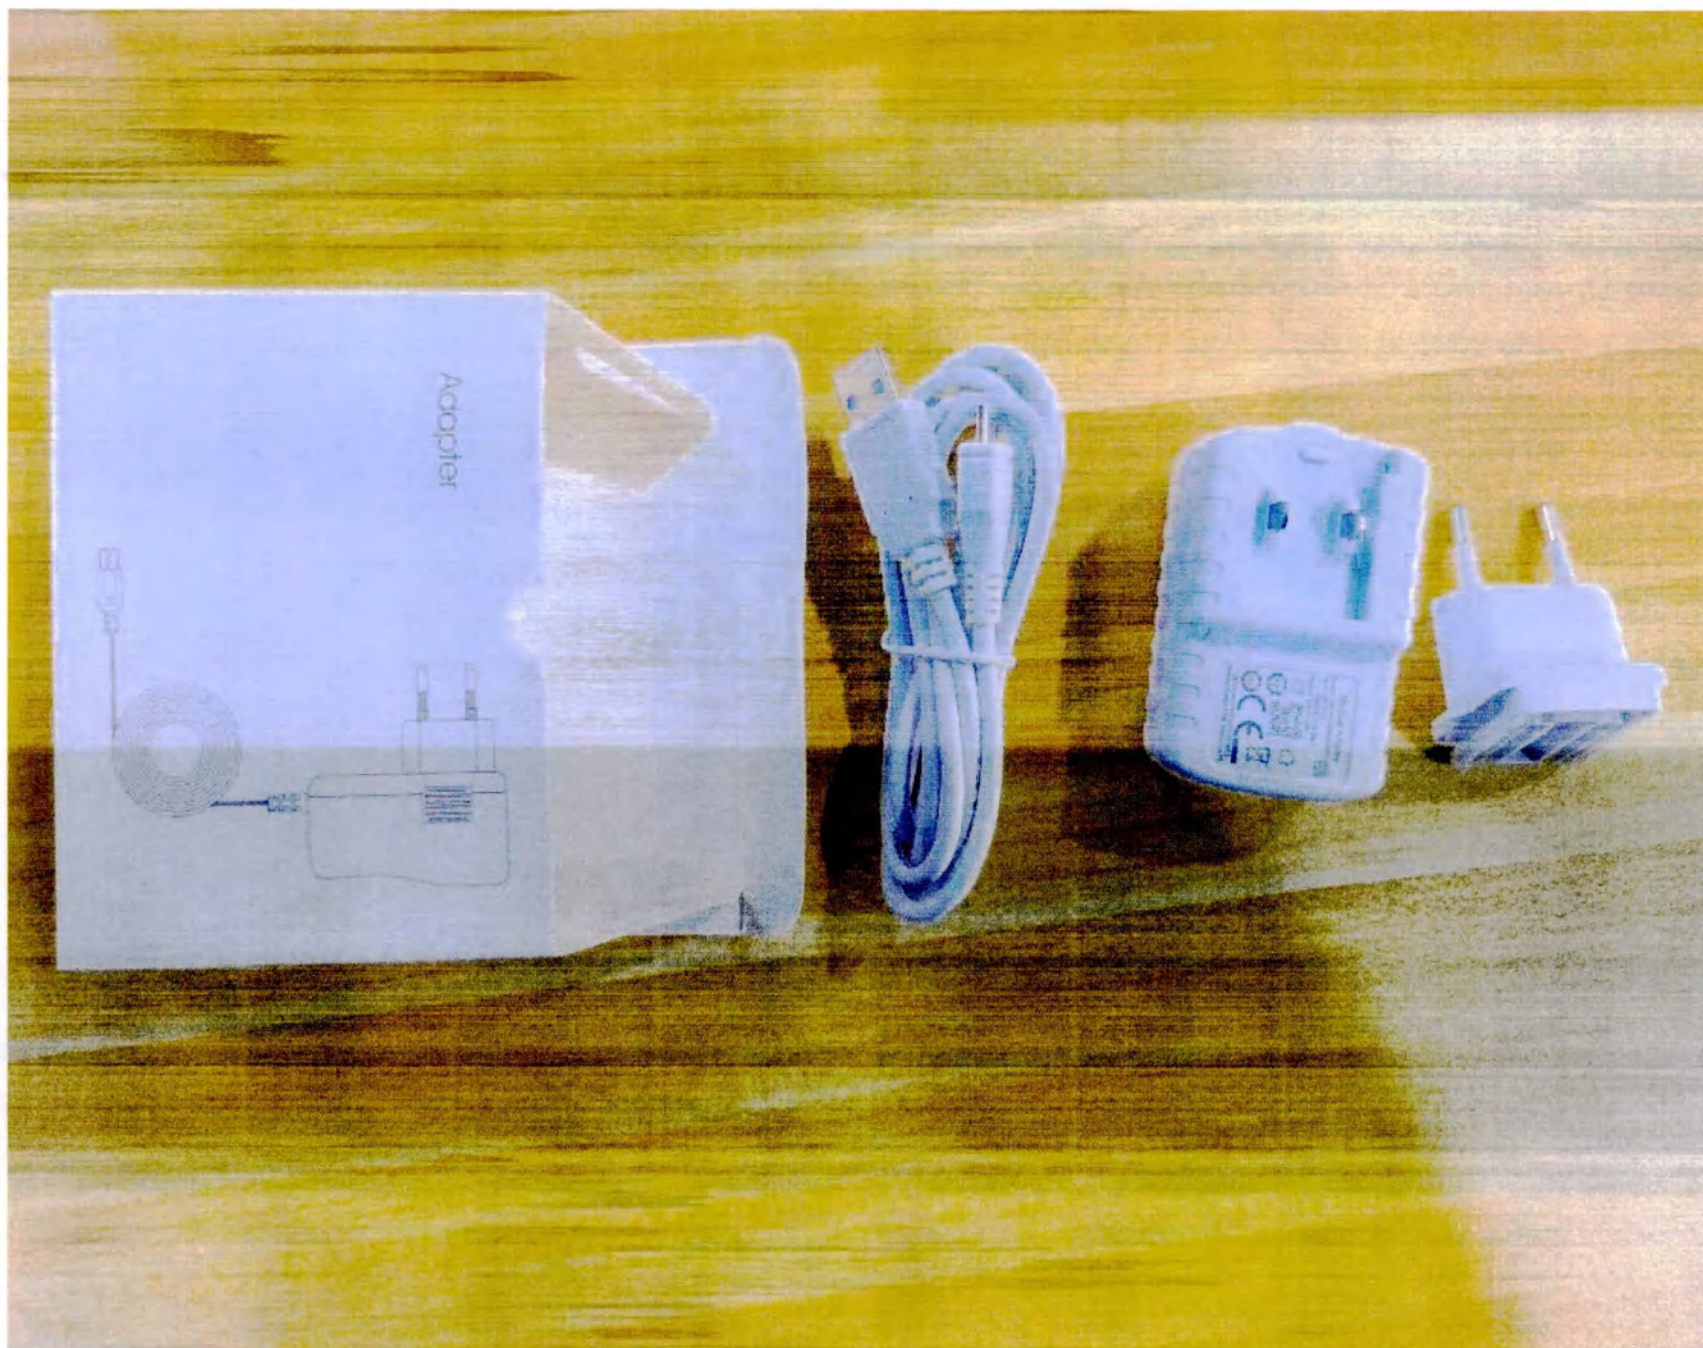

Фотографическое изображение 47 – Потребительская упаковка

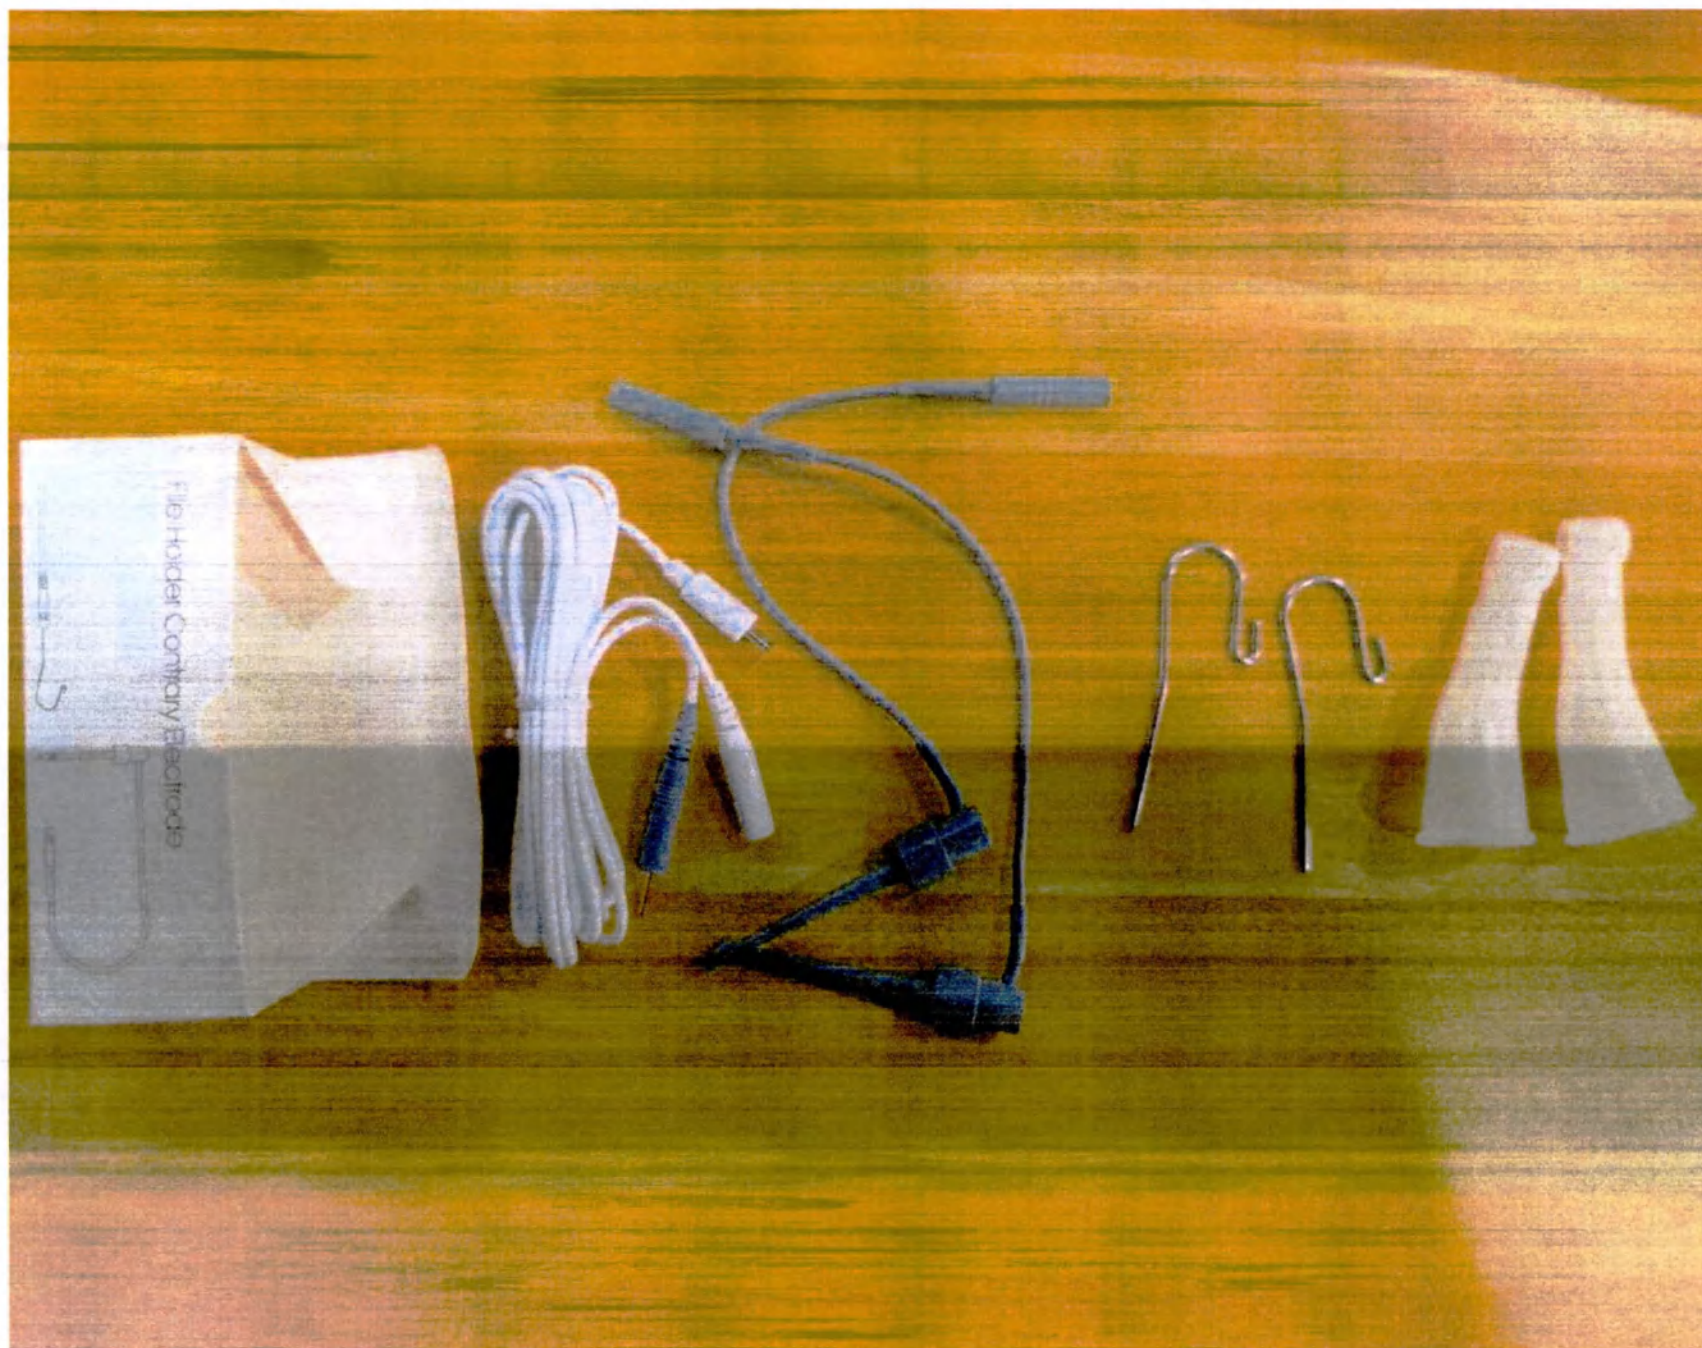

Фотографическое изображение 48 – Потребительская упаковка

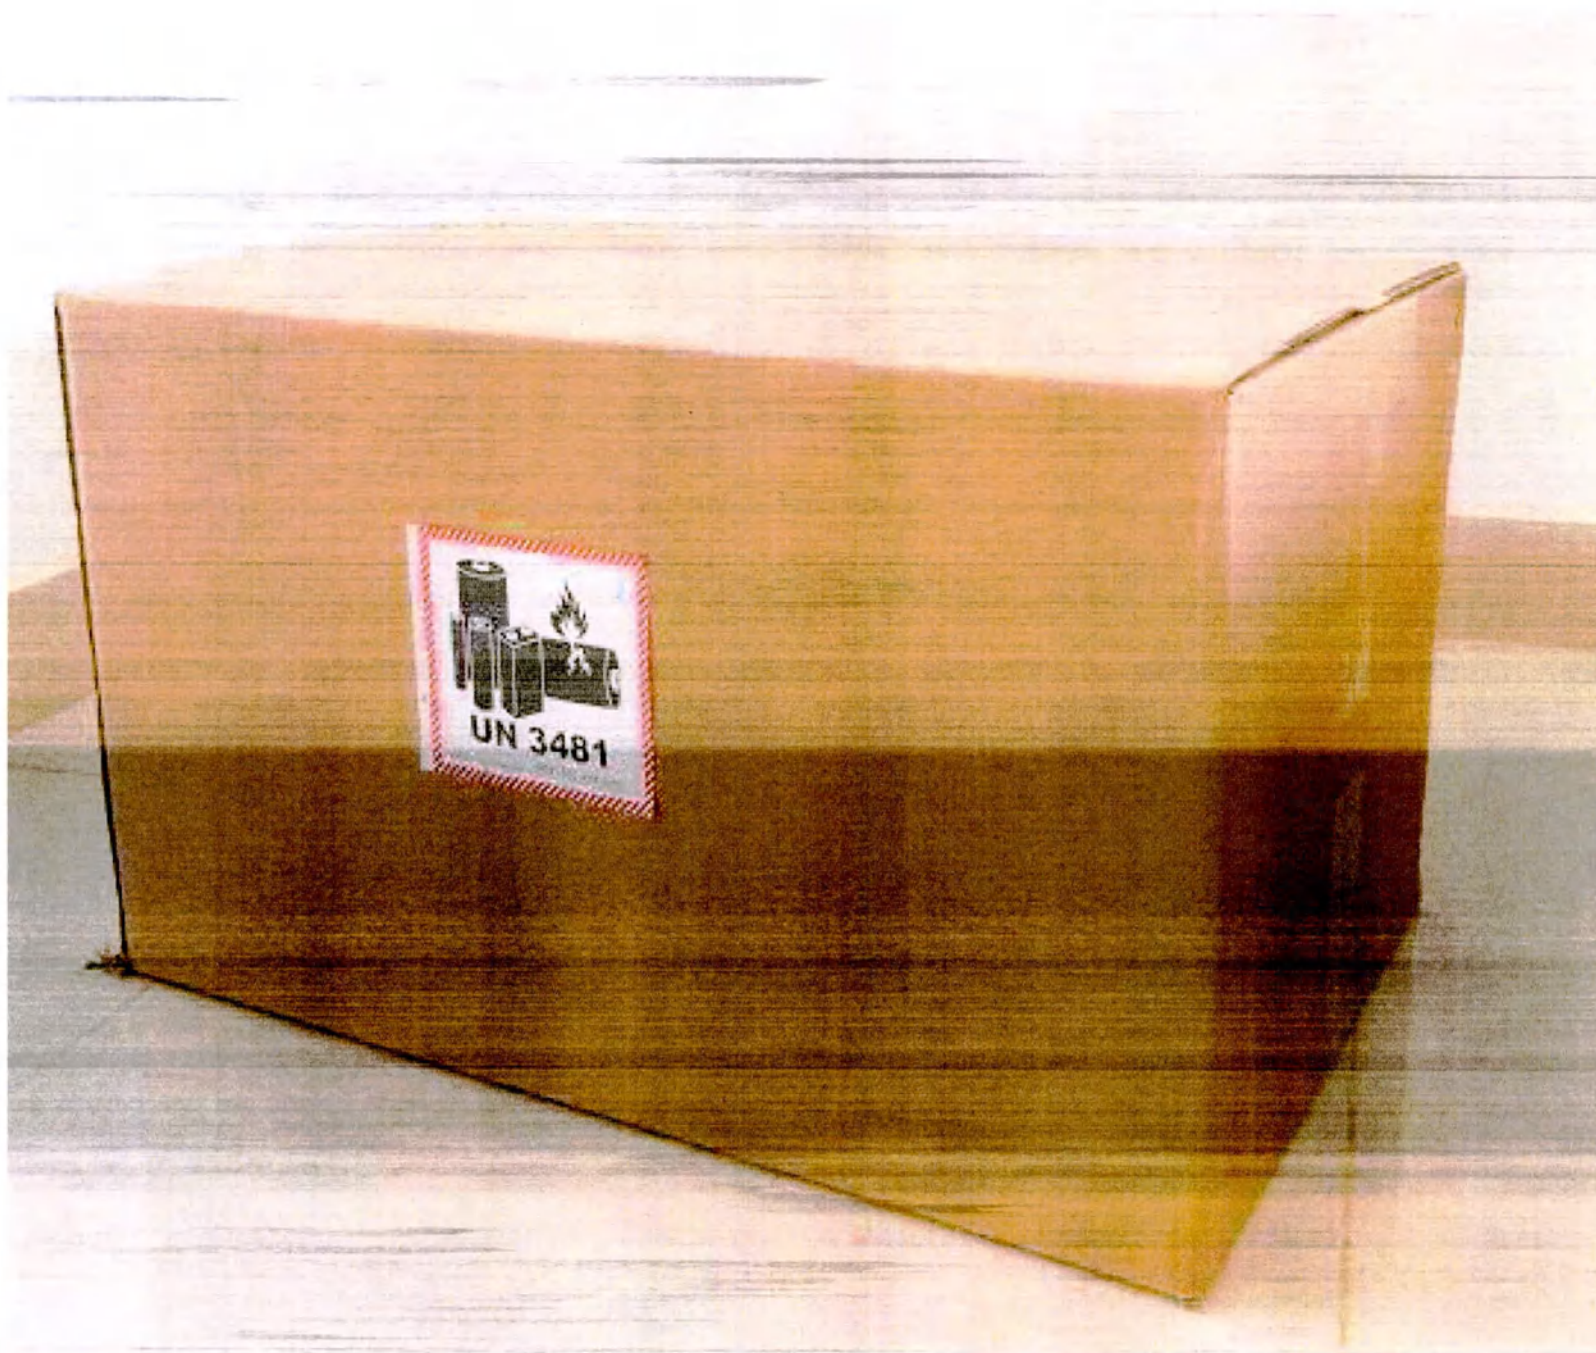


Фотографическое изображение 49 – Транспортная упаковка



Фотографическое изображение 50 – Транспортная упаковка

3. *Эндомотор проводной с апекслокатором, модель MR-Auto-Motor*

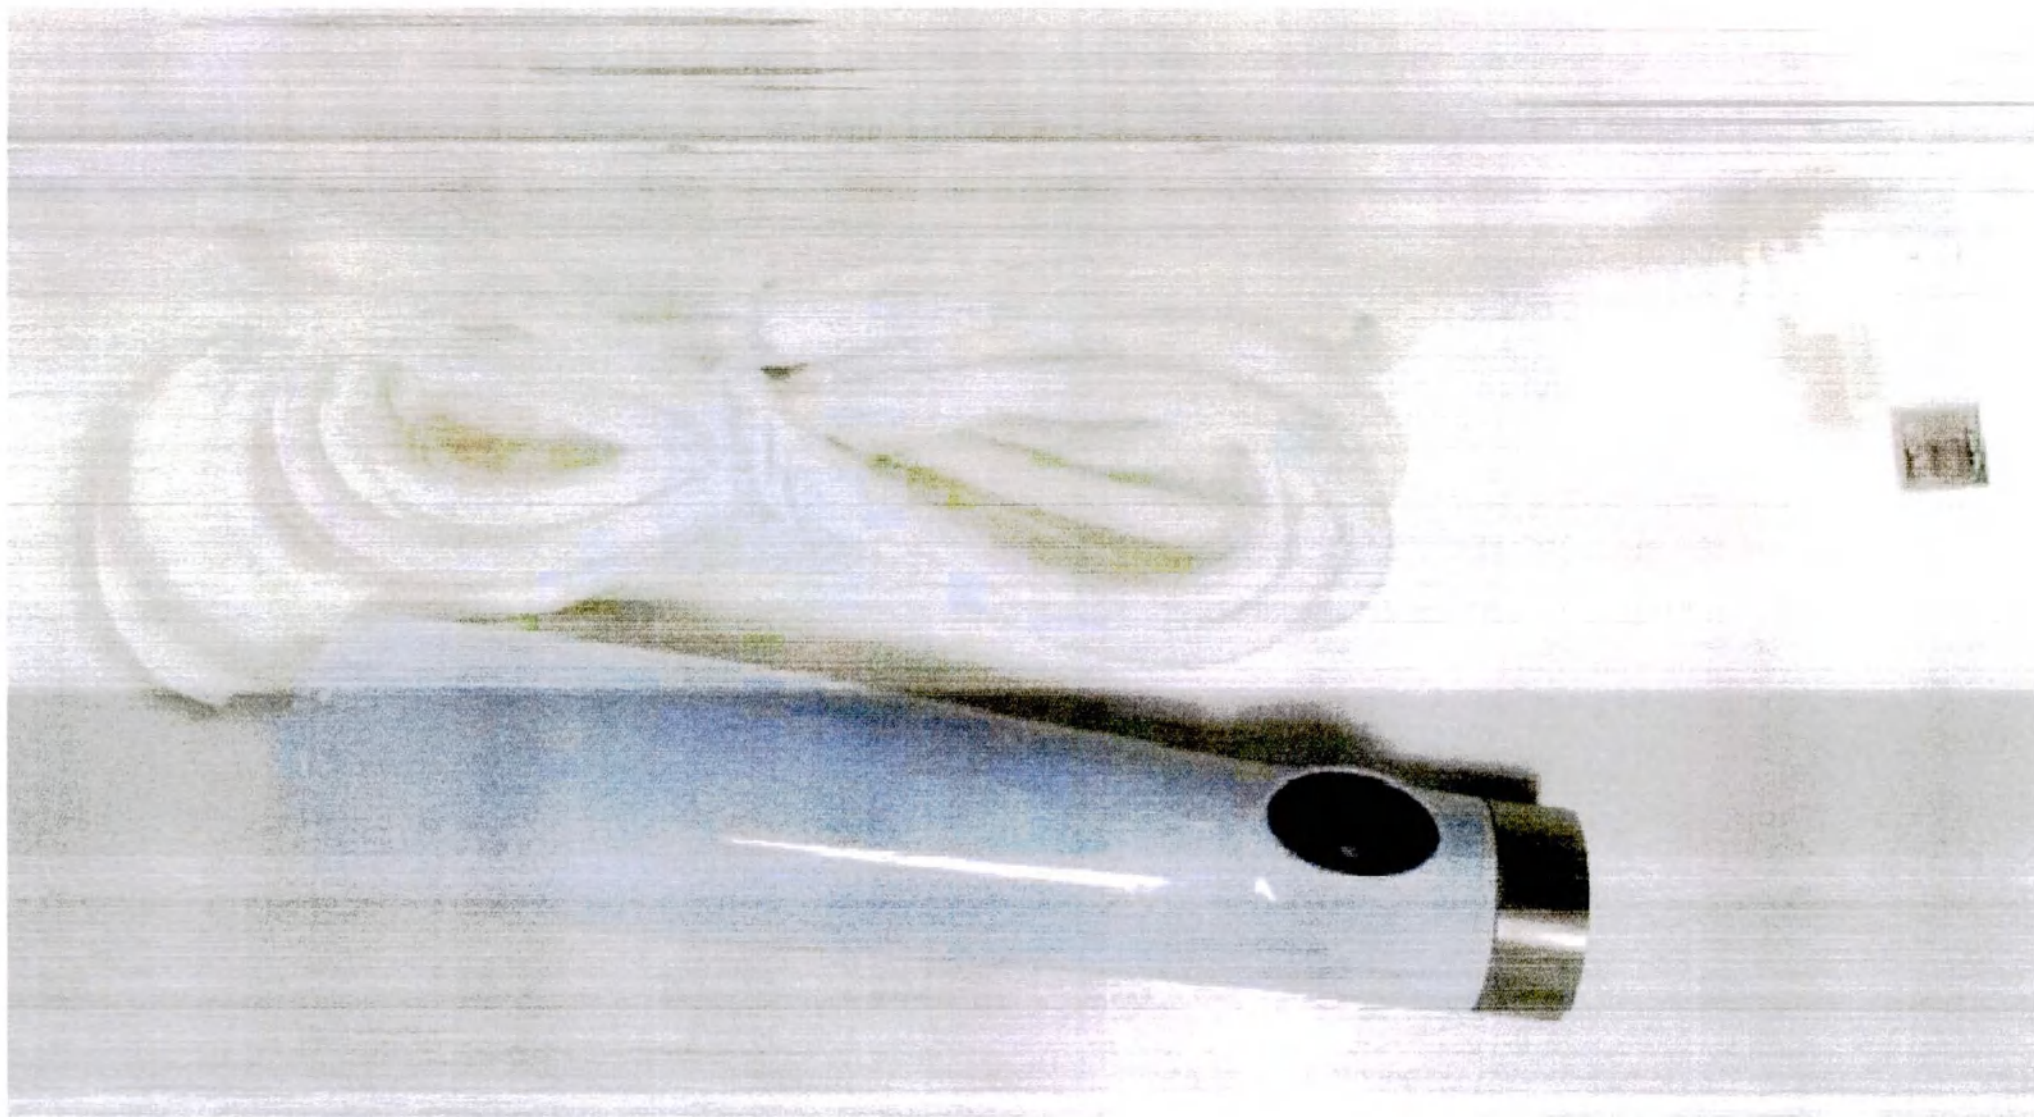

Фотографическое изображение 51 – Эндомотор проводной с апекслокатором, модель MR-Auto-Motor (вид спереди)




Фотографическое изображение 52 – Эндомотор проводной с апекслокатором, модель MR-Auto-Motor (вид спереди)




Фотографическое изображение 53 – Моторный наконечник с эндомотором (общий вид)



Фотографическое изображение 54 – Моторный накопечник (общий вид)

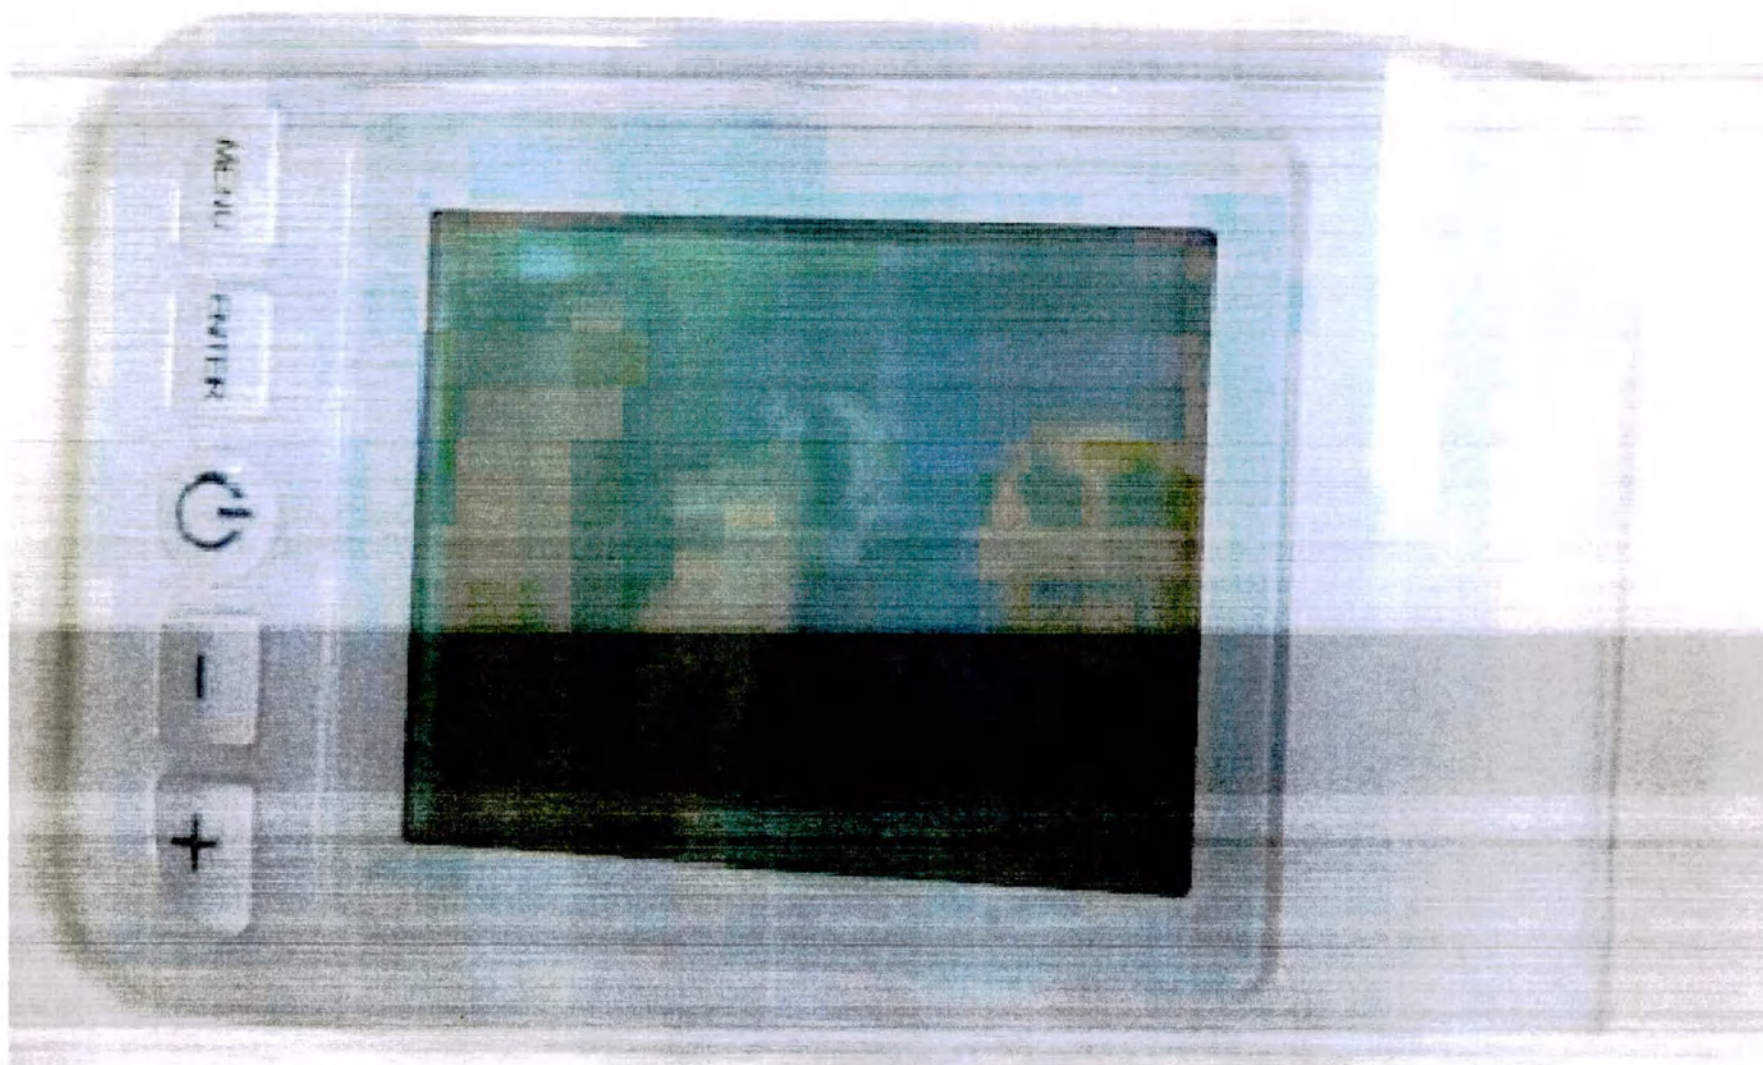

Фотографическое изображение 55 – Моторный наконечник (вид спереди)

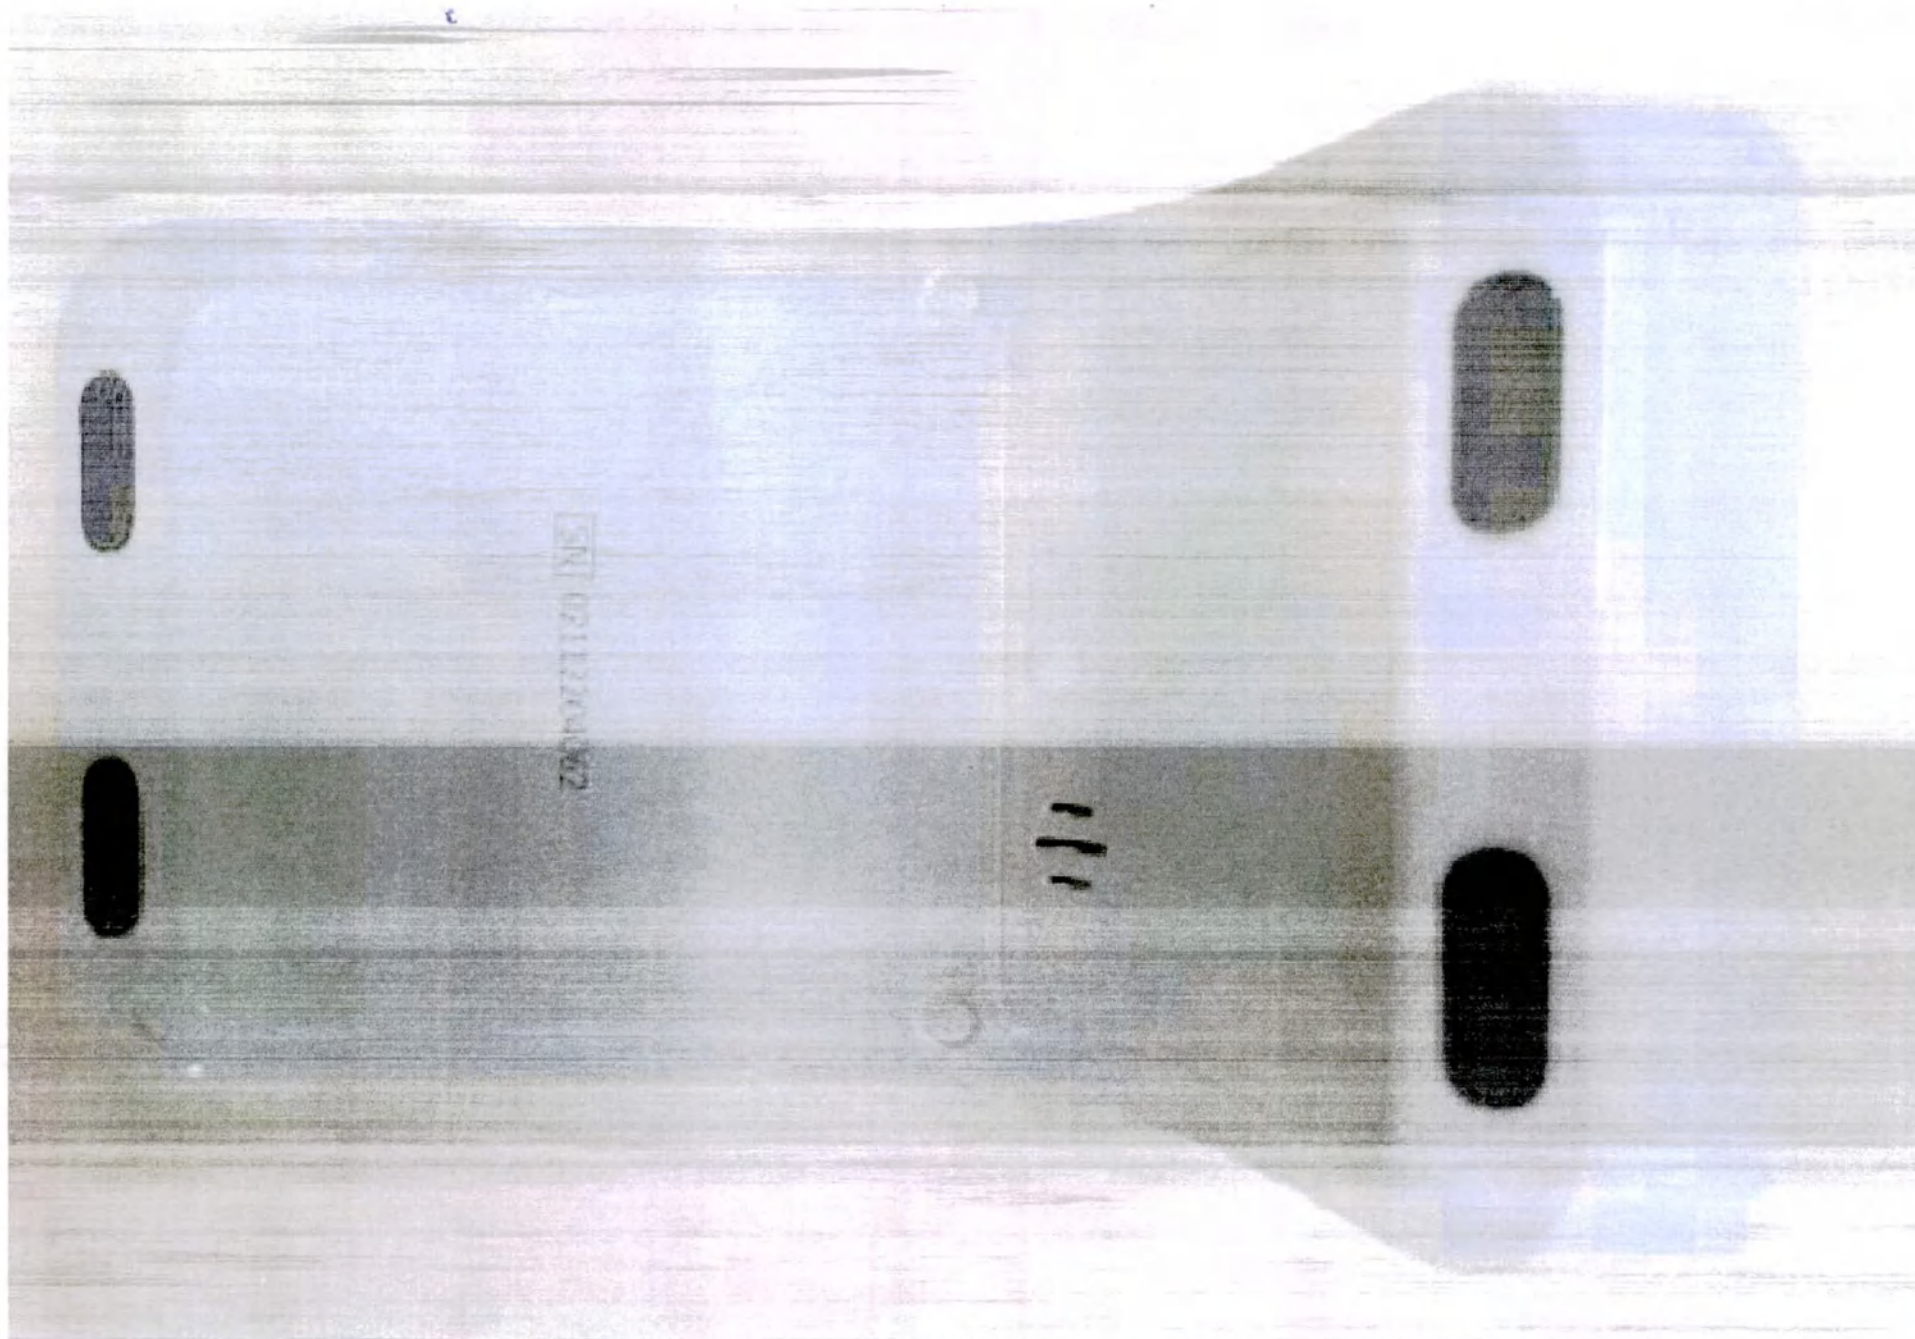

Фотографическое изображение 56 – Моторный наконечник (вид снизу)




Фотографическое изображение 57 – Контругловый наконечник, модель E-BCA11-A (вид спереди)




Фотографическое изображение 58 – Контругловой наконечник, модель E-BCA11-A (вид сзади)



Фотографическое изображение 59 – Контругловой наконечник, модель E-BCA11-A (вид сбоку)

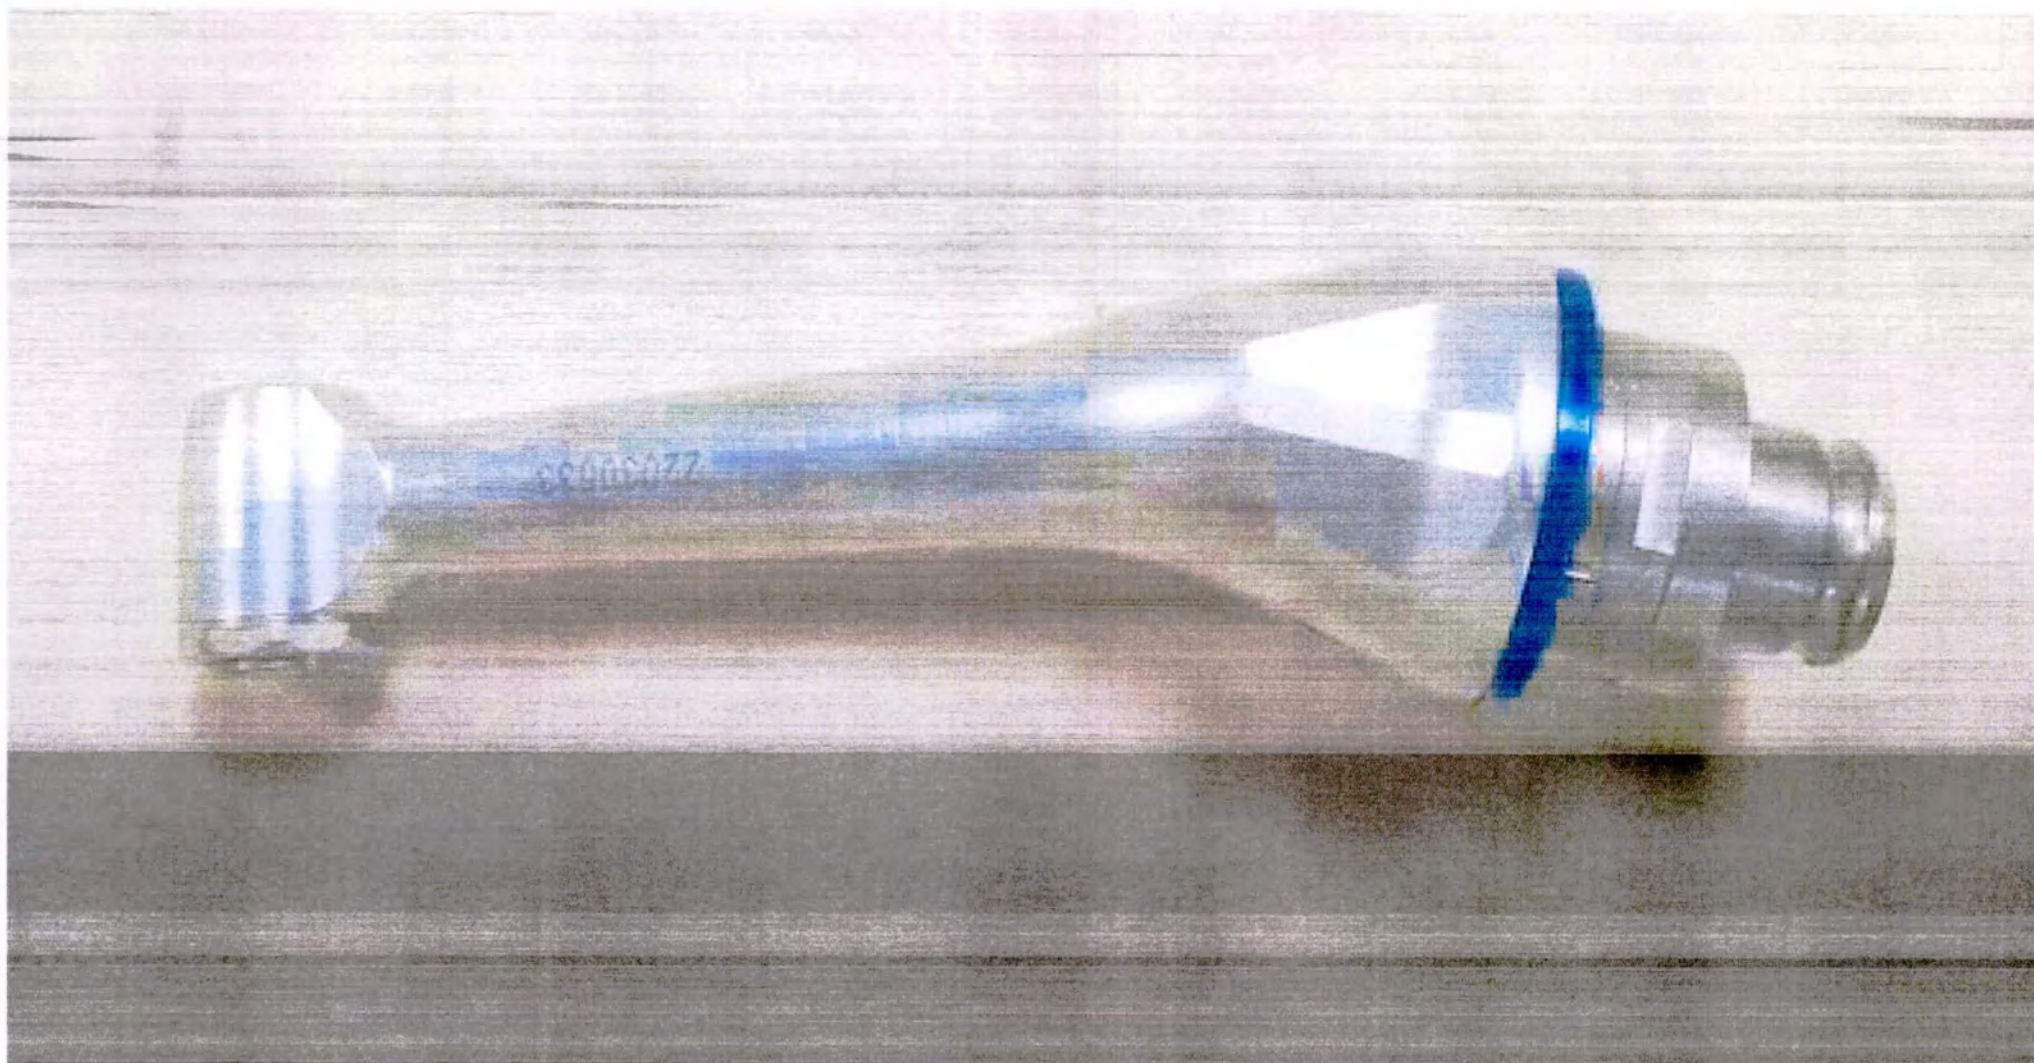

Фотографическое изображение 60 – Контругловой наконечник, модель E-BCA11-A (вид сбоку)

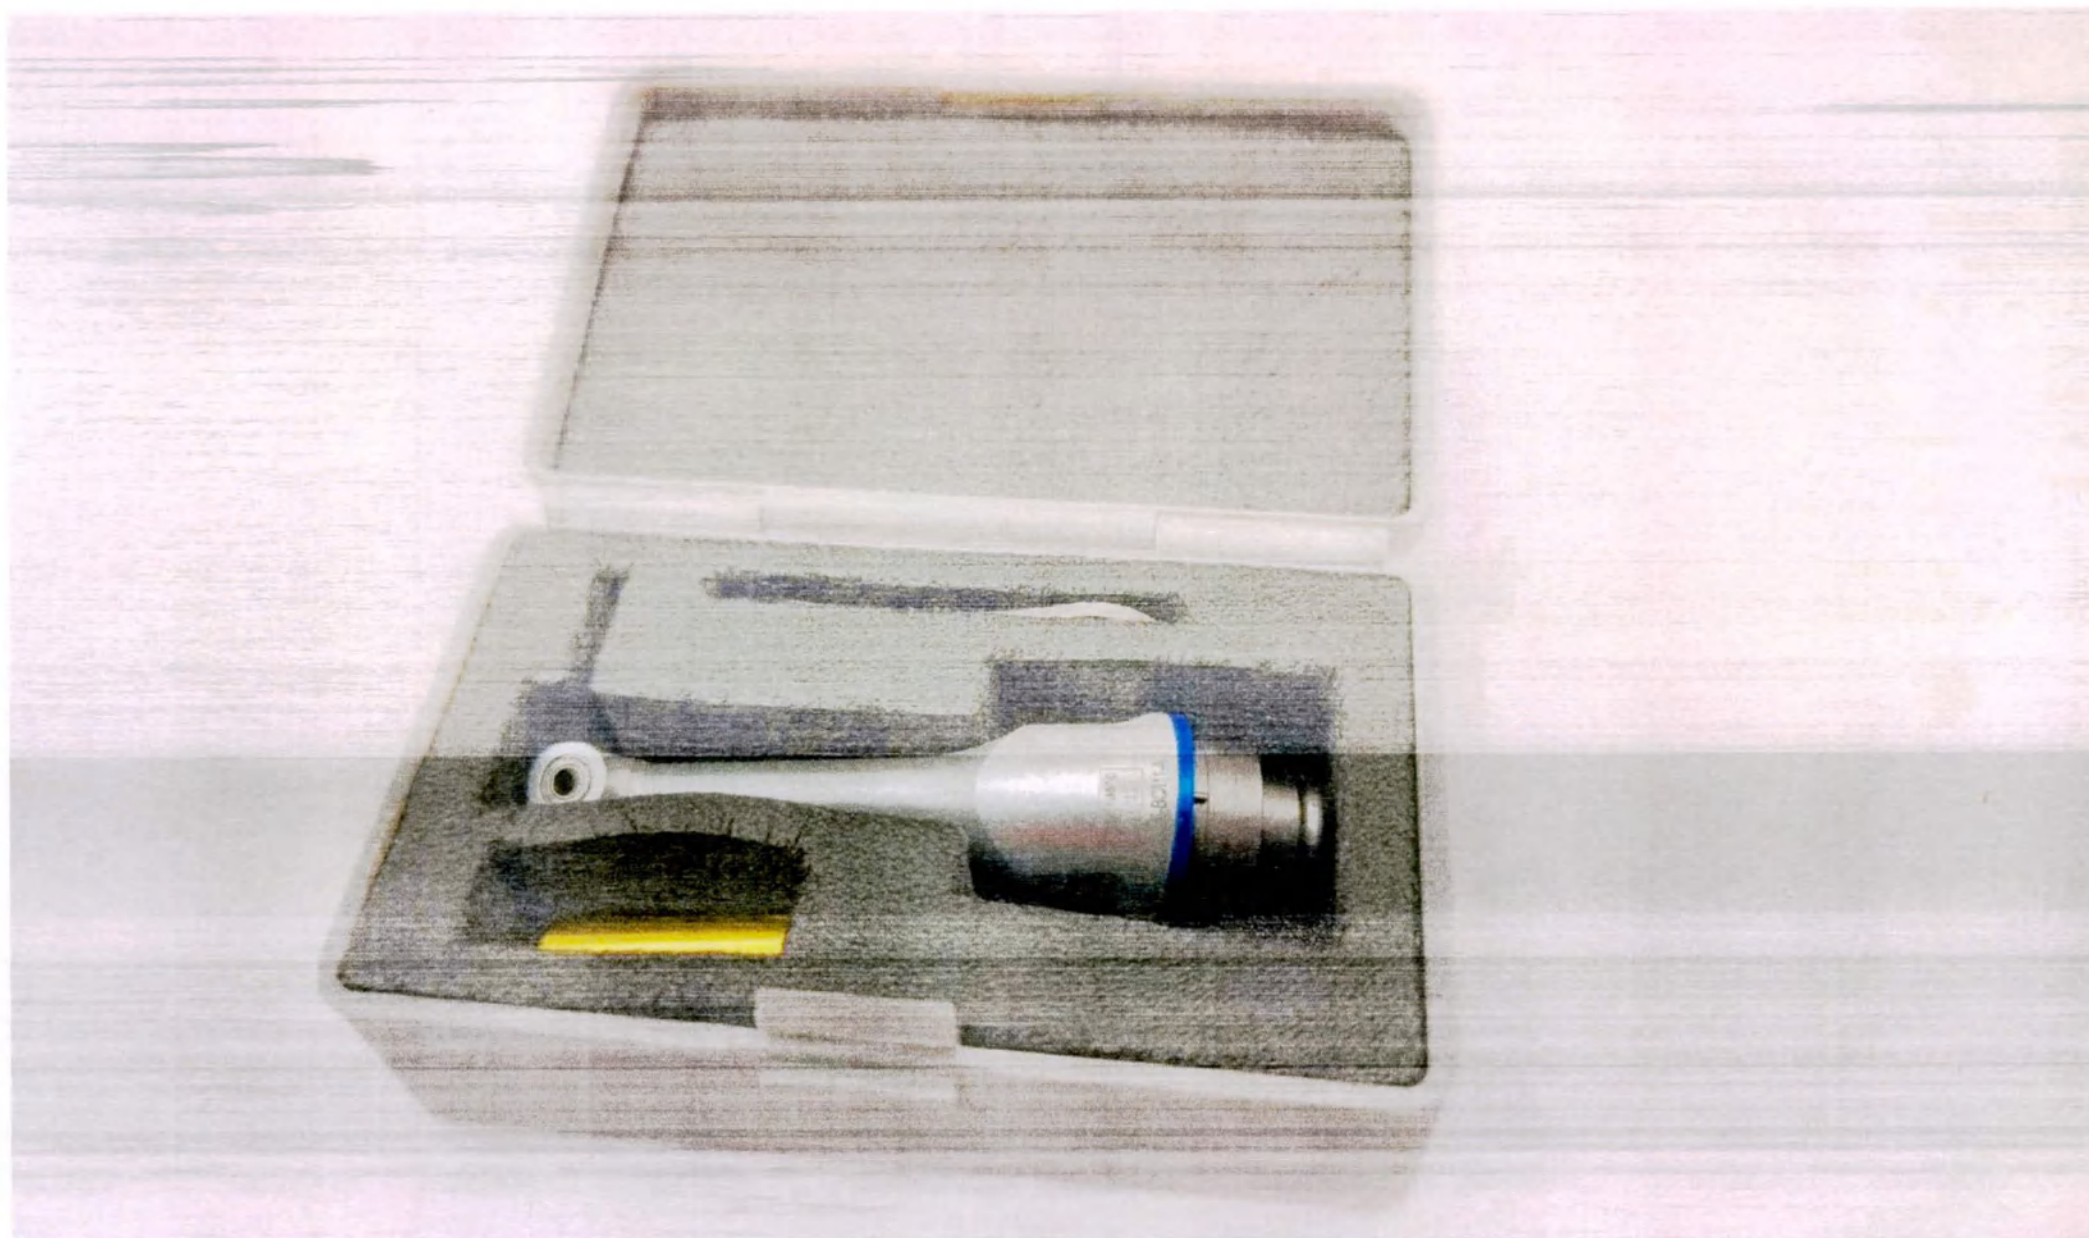


Фотографическое изображение 61 – Конфигурационный наконечник, модель E-BCA11-A (в упаковке)




Фотографическое изображение 62 – Адаптер питания в составе

Фототрафикское изображение 63 – Адаптер питания



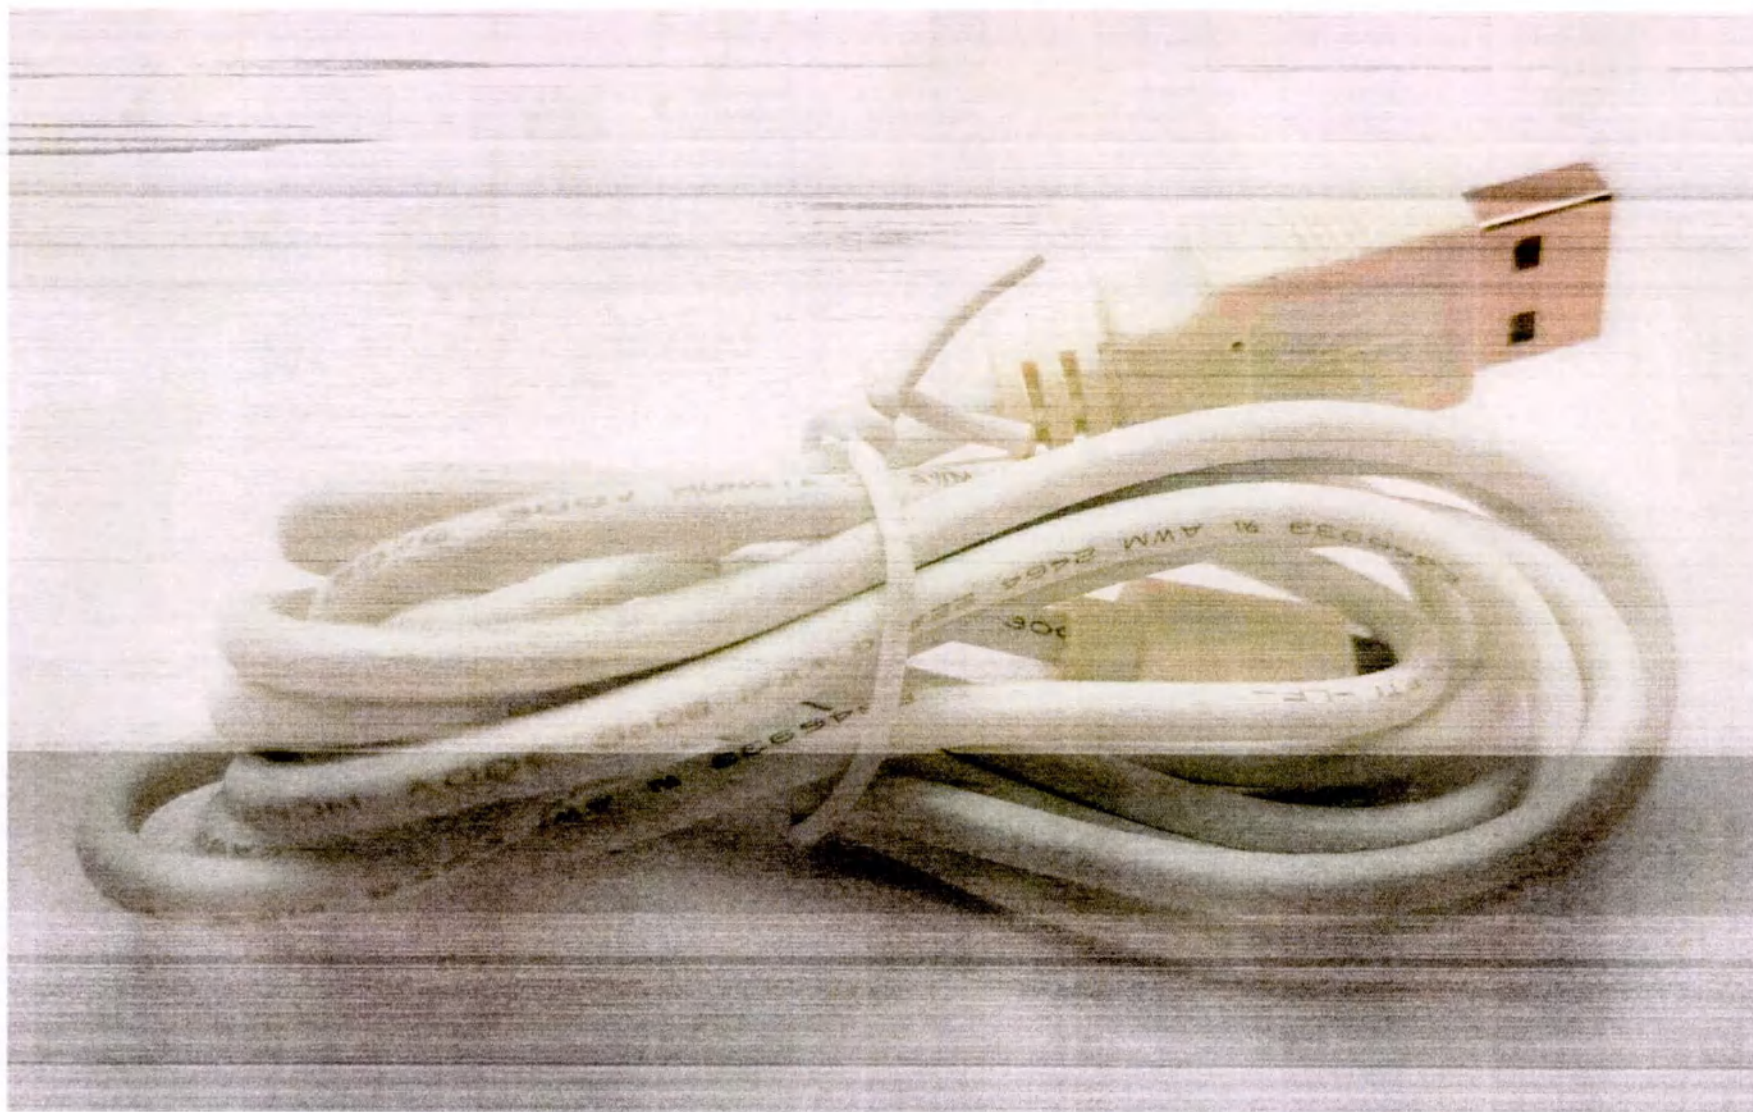


Фотографическое изображение 64 – Кабель питания

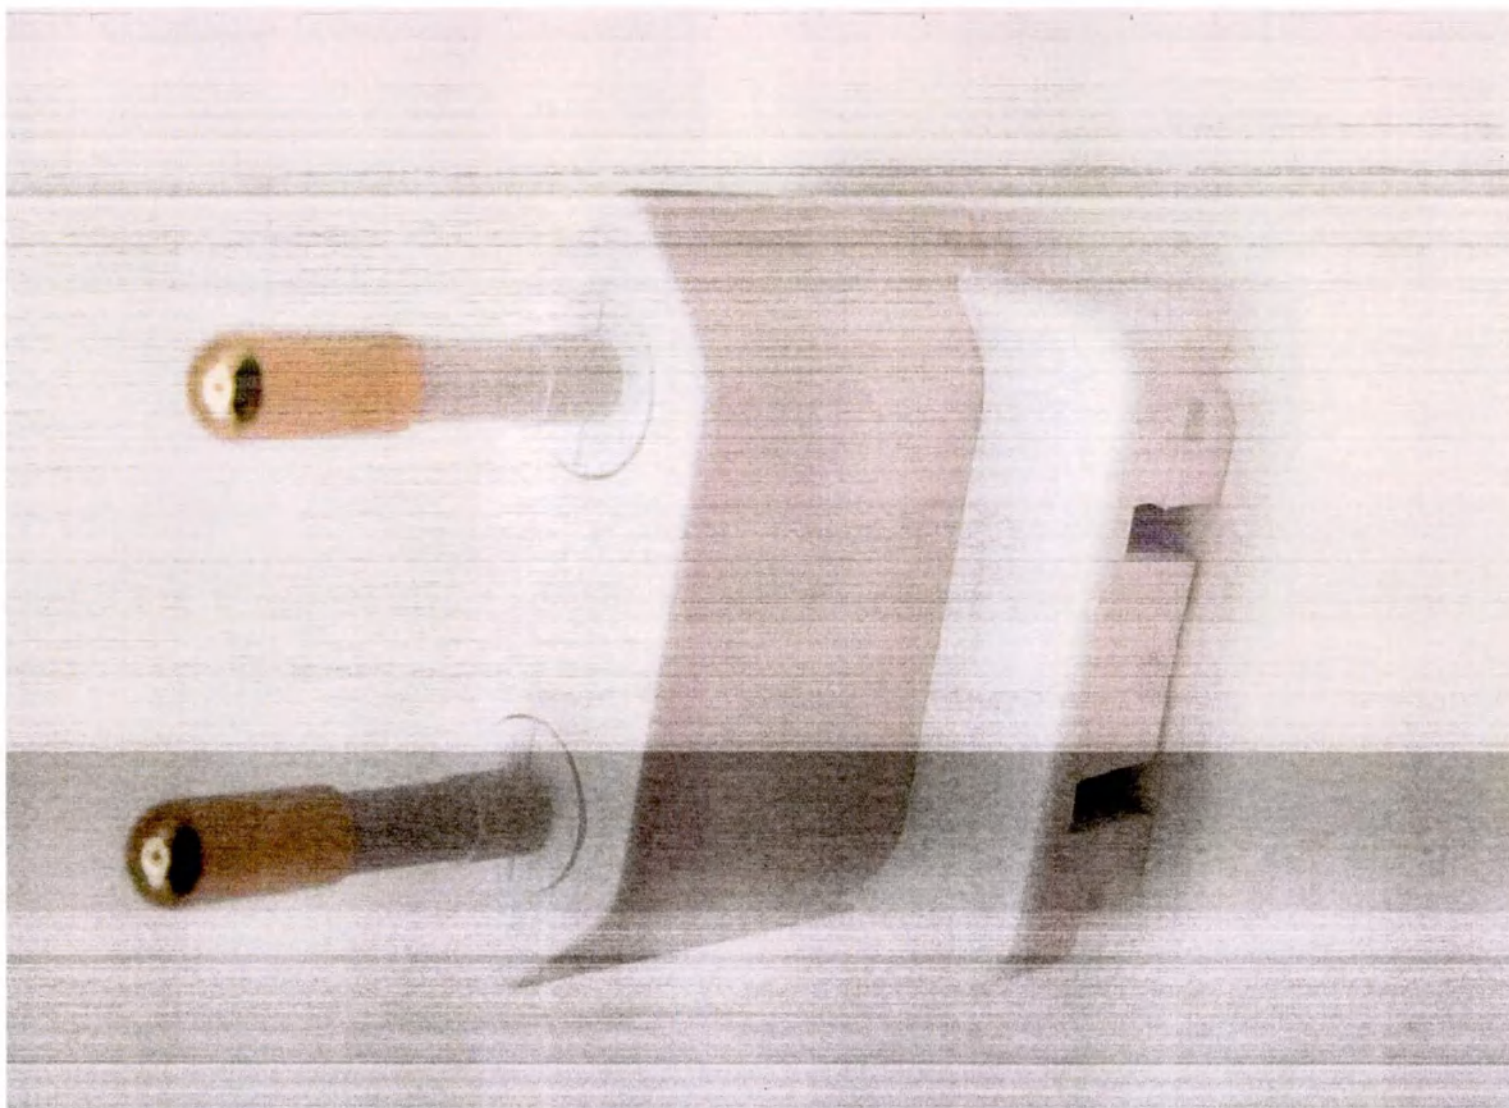


Фотографическое изображение 65 – Переходник для адаптера питания



Фотографическое изображение 66 – Подставка с эндомотором и моторным наконечником (общий вид)

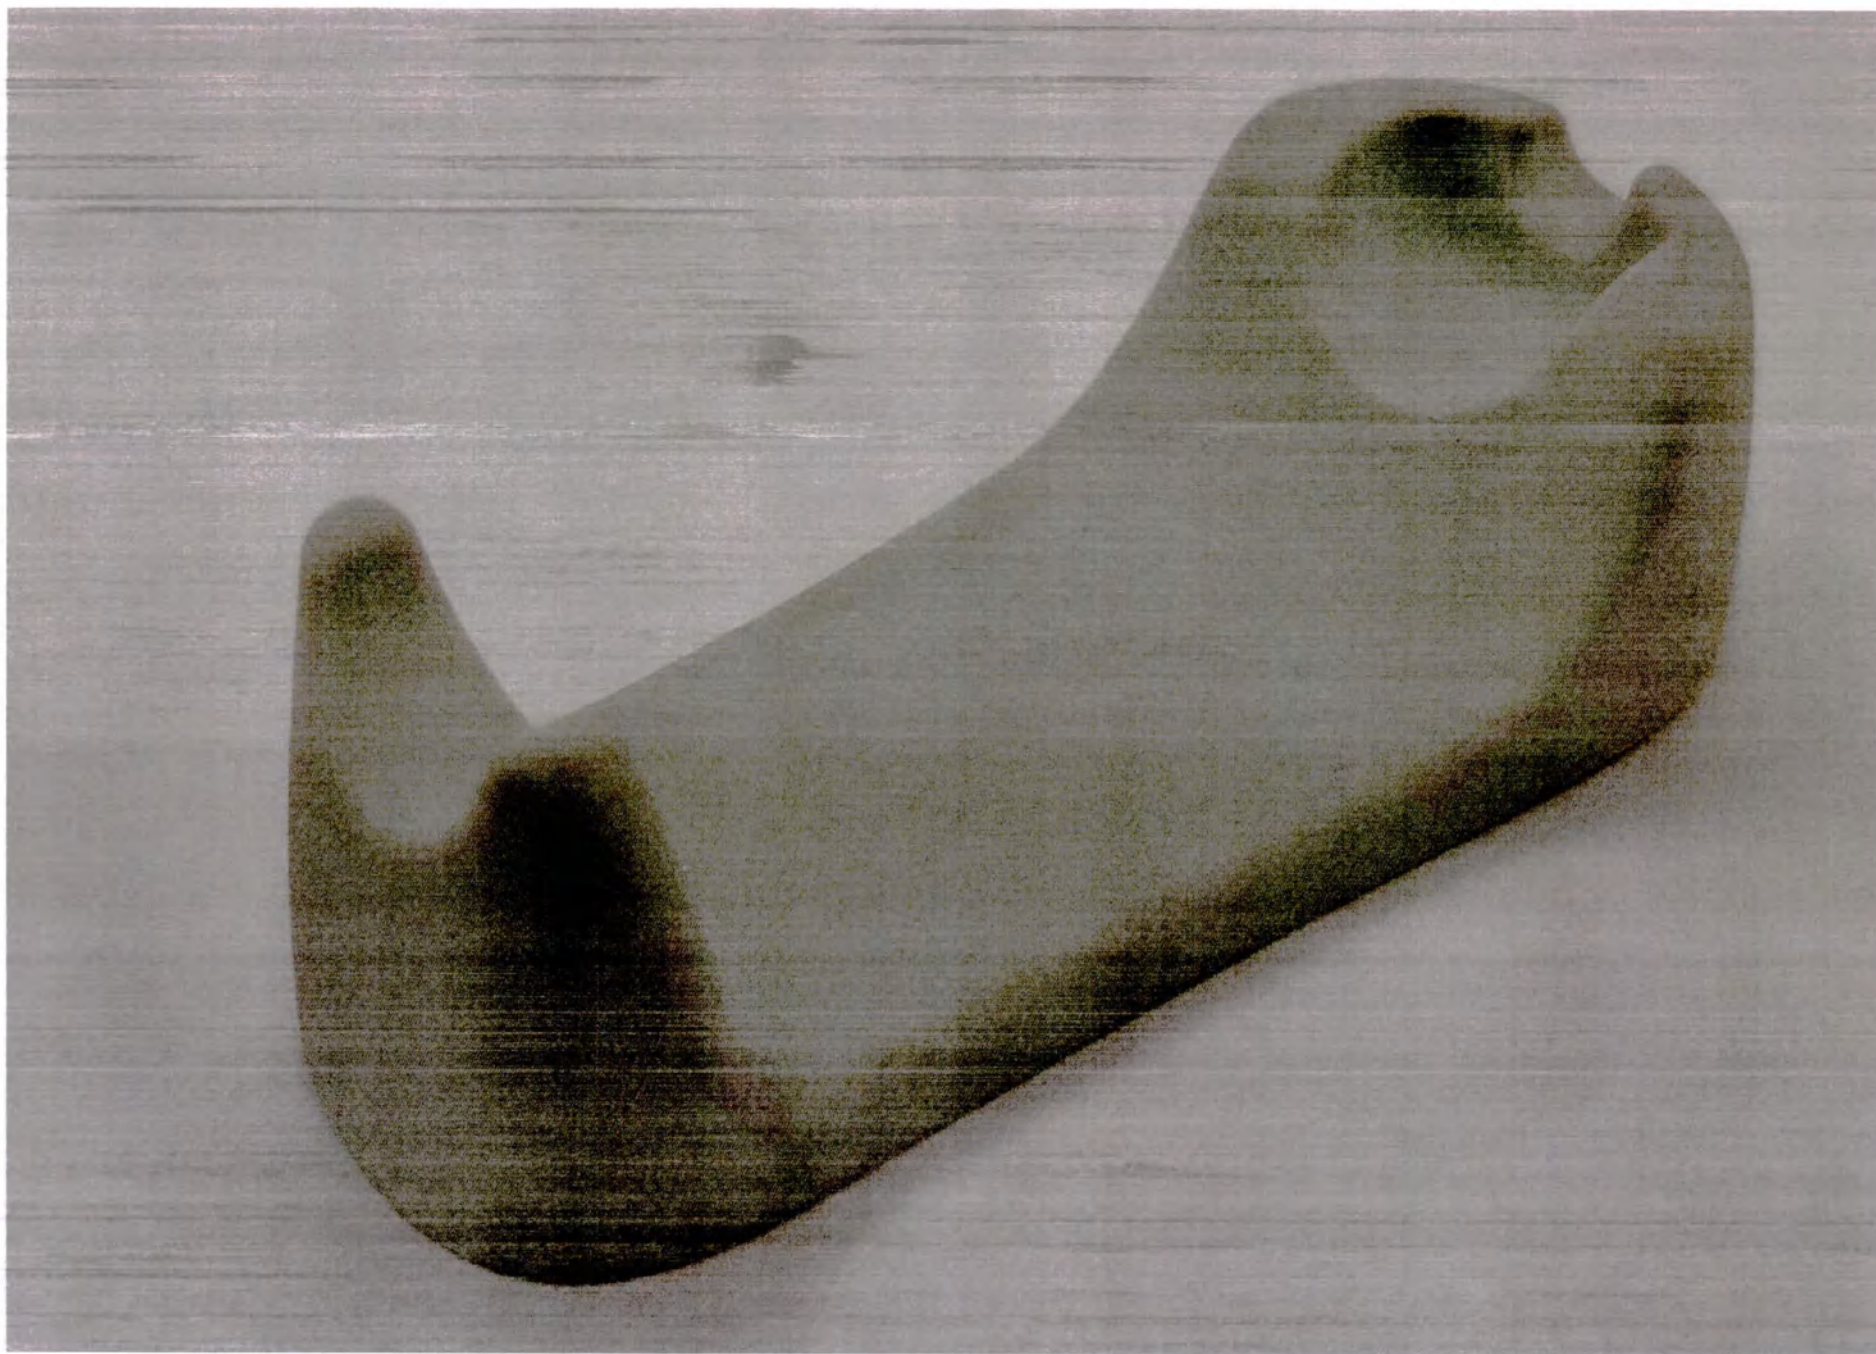

Фотографическое изображение 67 – Подставка (общий вид)

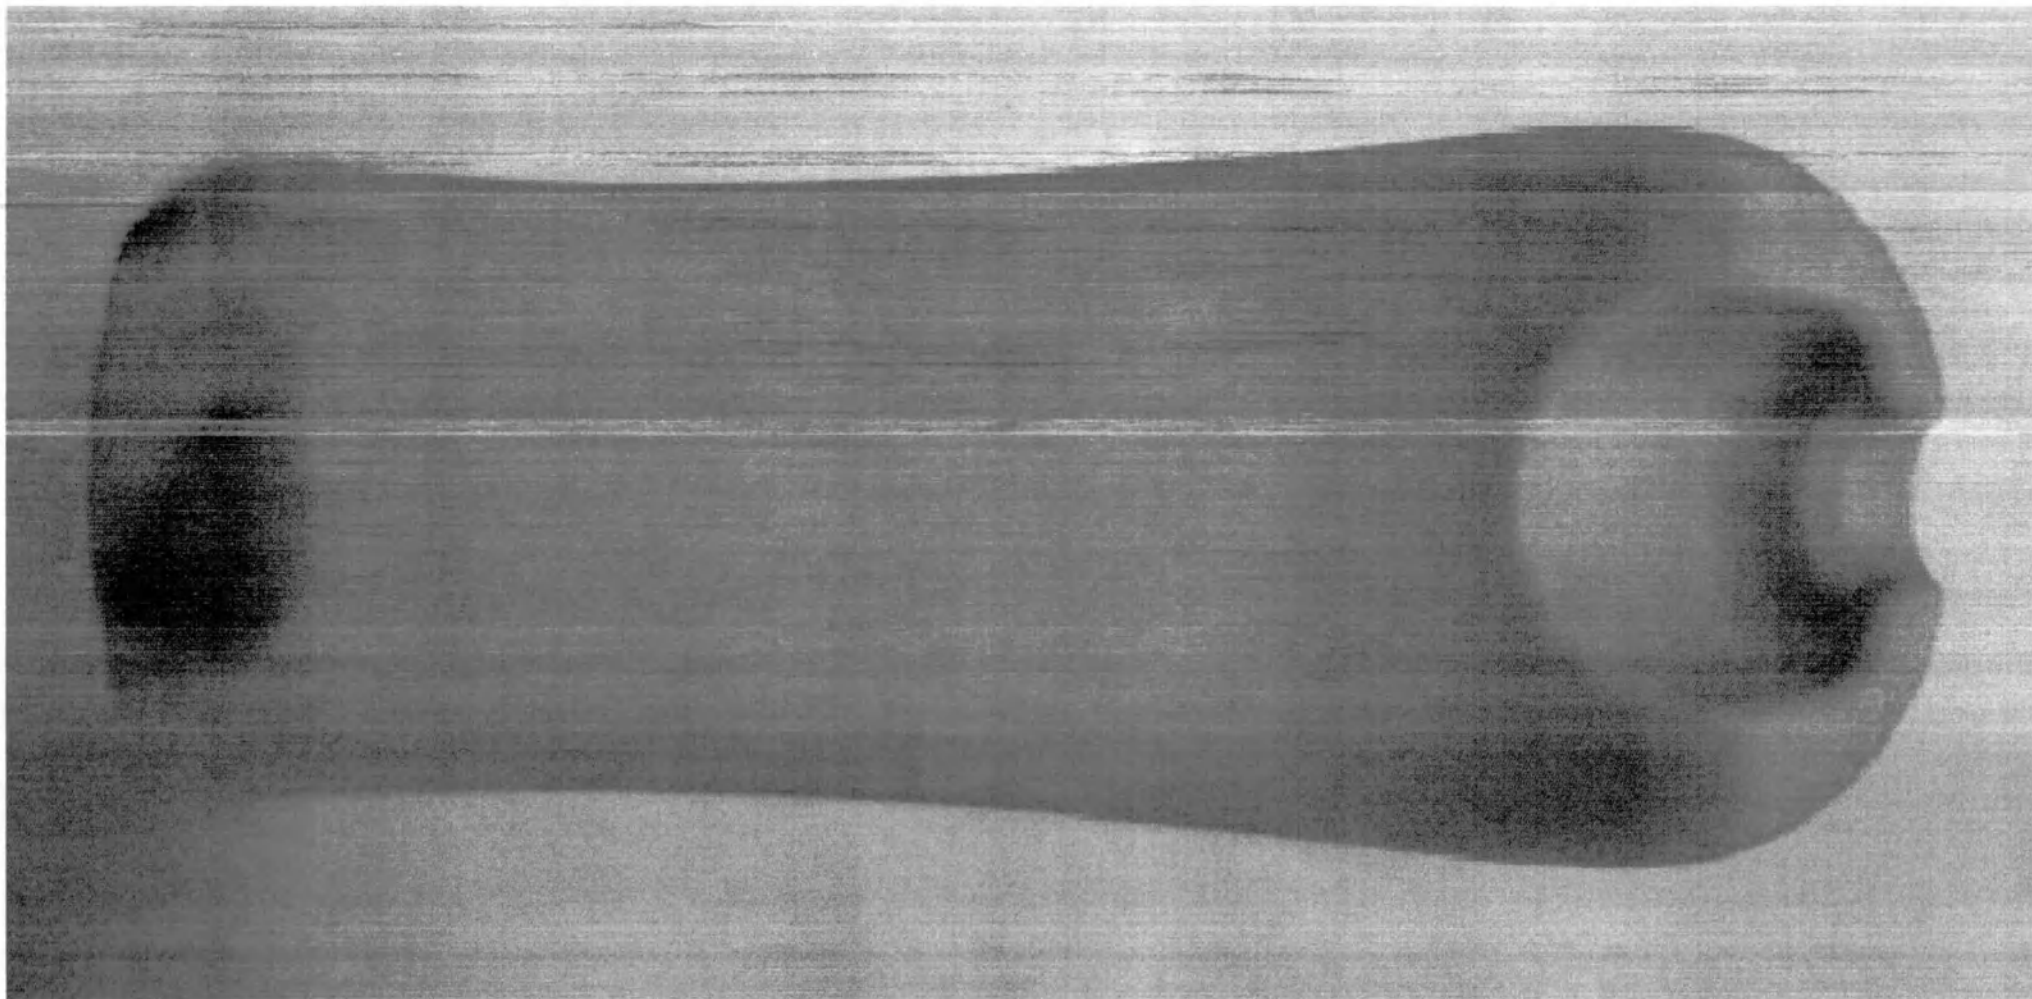


Фотографическое изображение 68 – Подставка (вид сверху)




Фотографическое изображение 69 – Подставка (вид снизу)




Фотографическое изображение 70 – Тестер, модель Apex Endo Motor

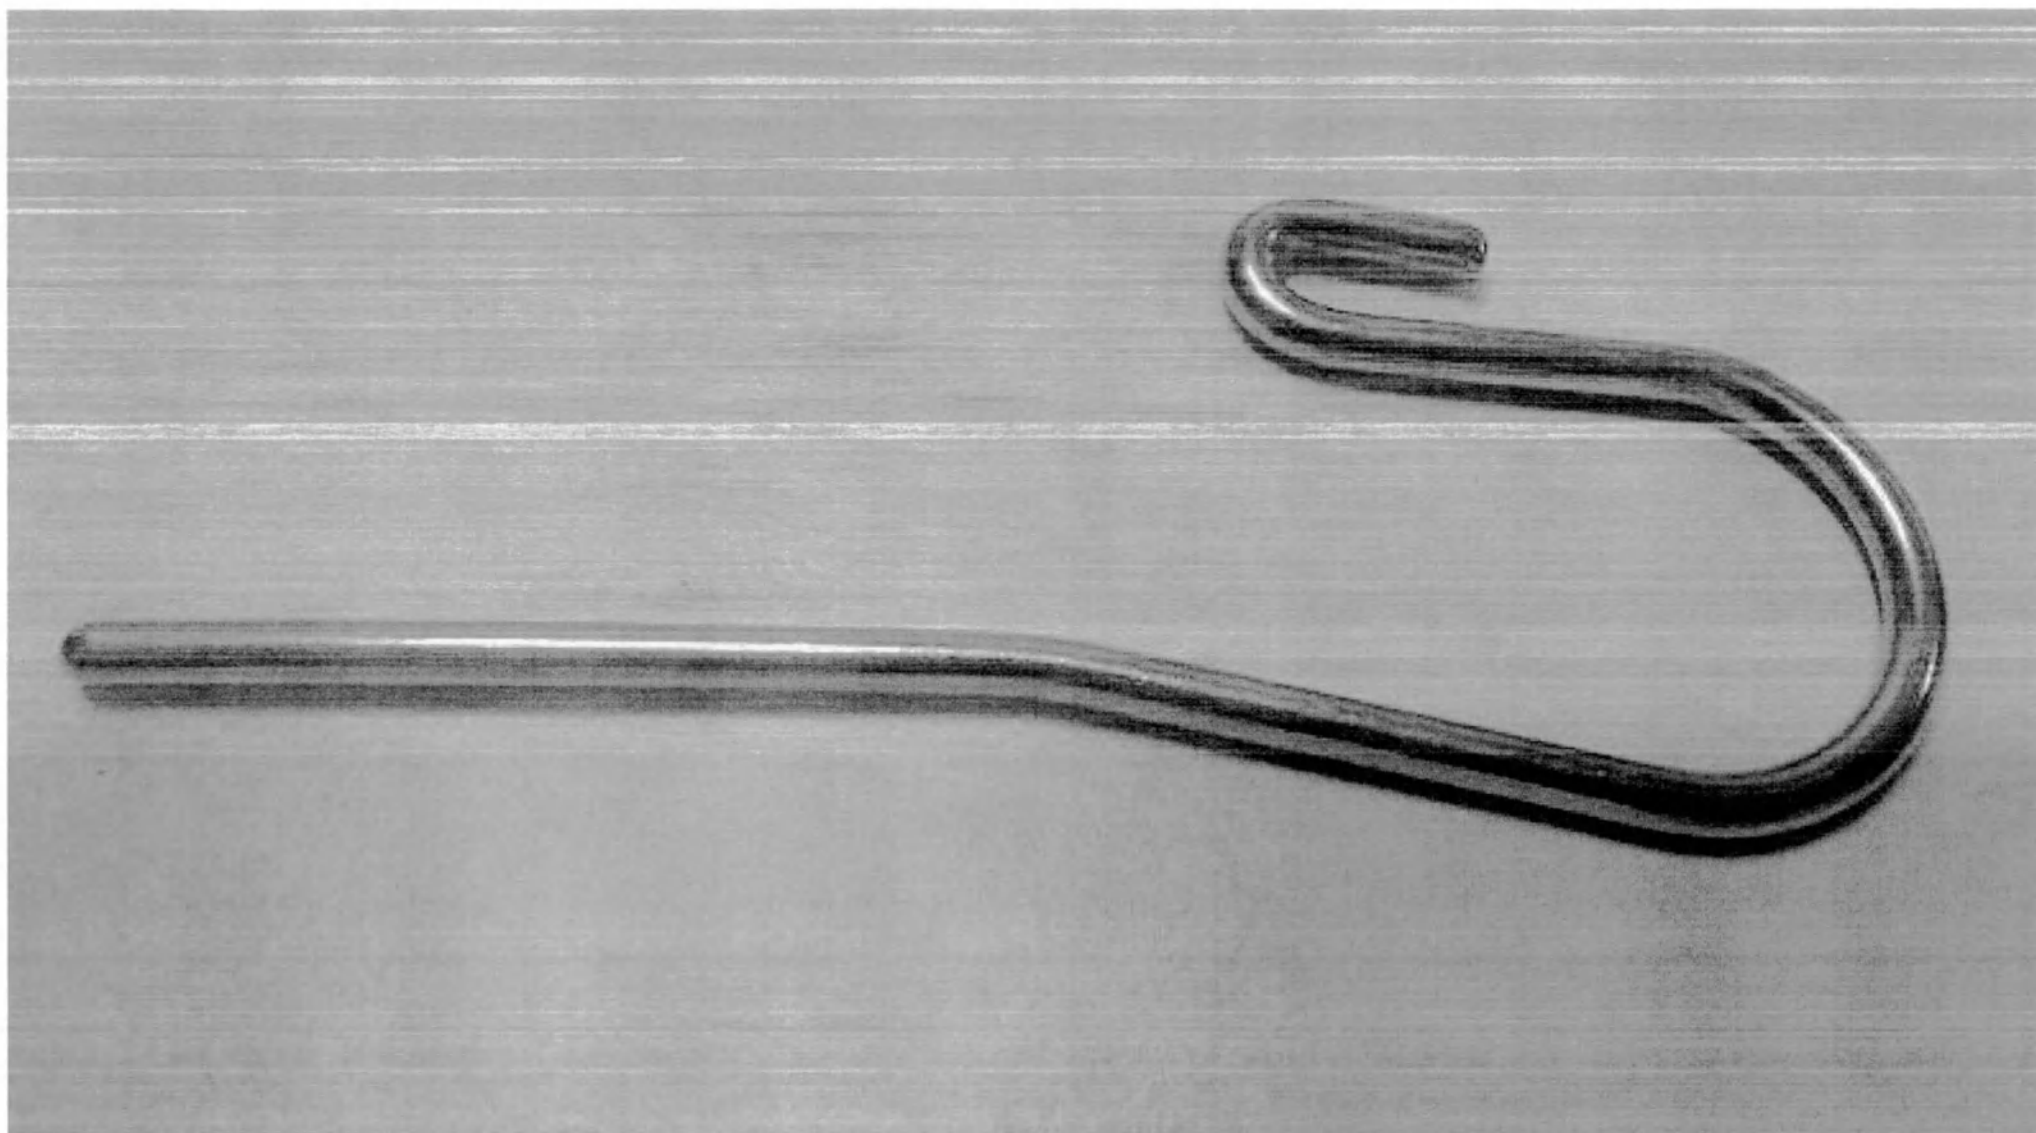

Фотографическое изображение 71 – Загубник

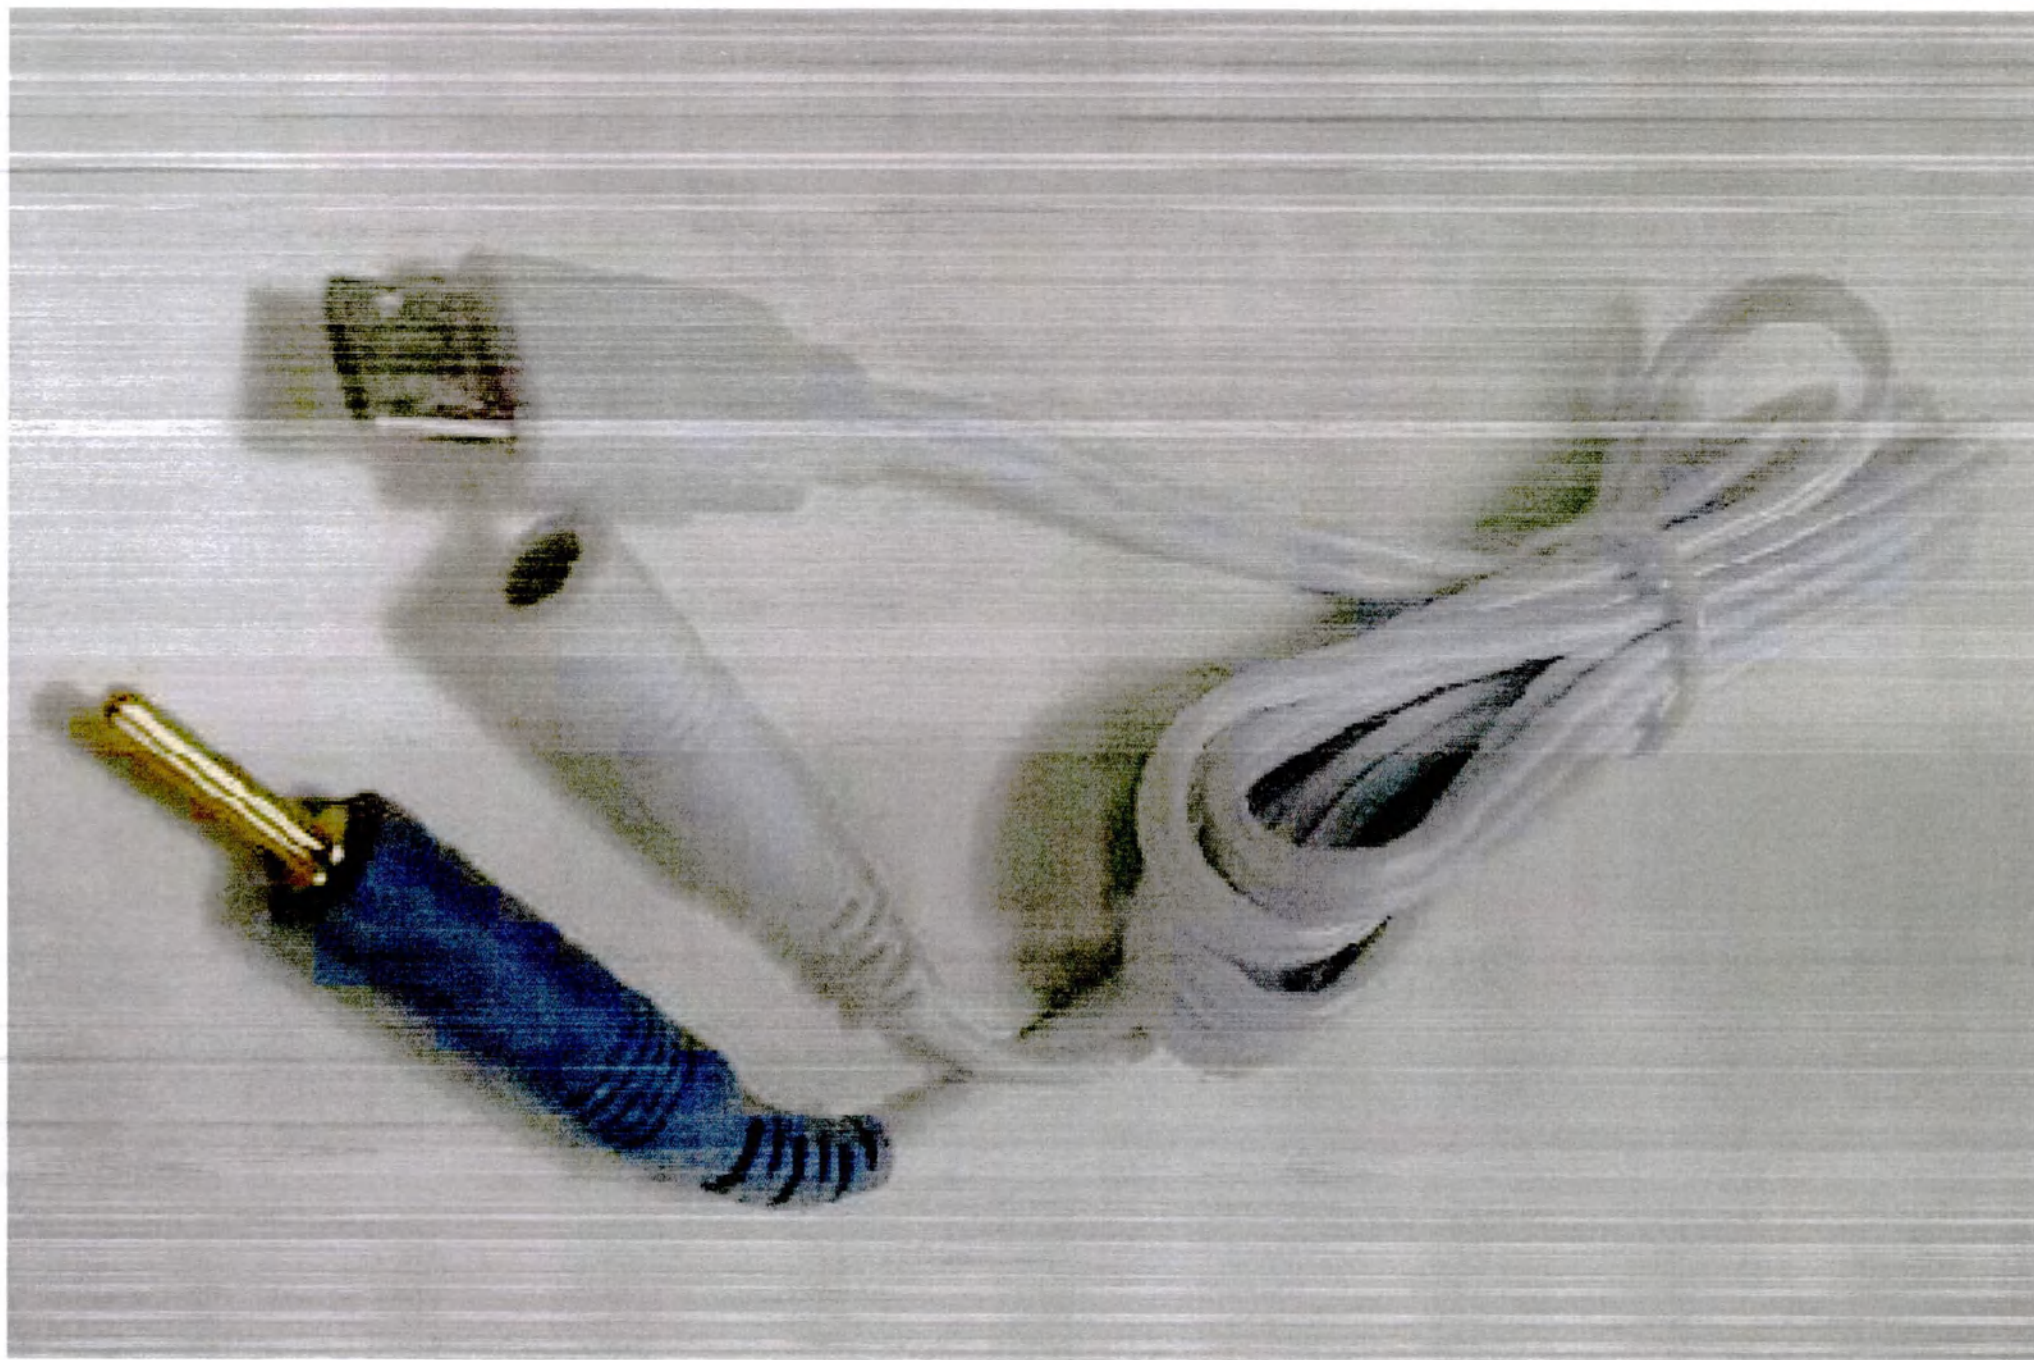


Фотографическое изображение 72 – Измерительный провод

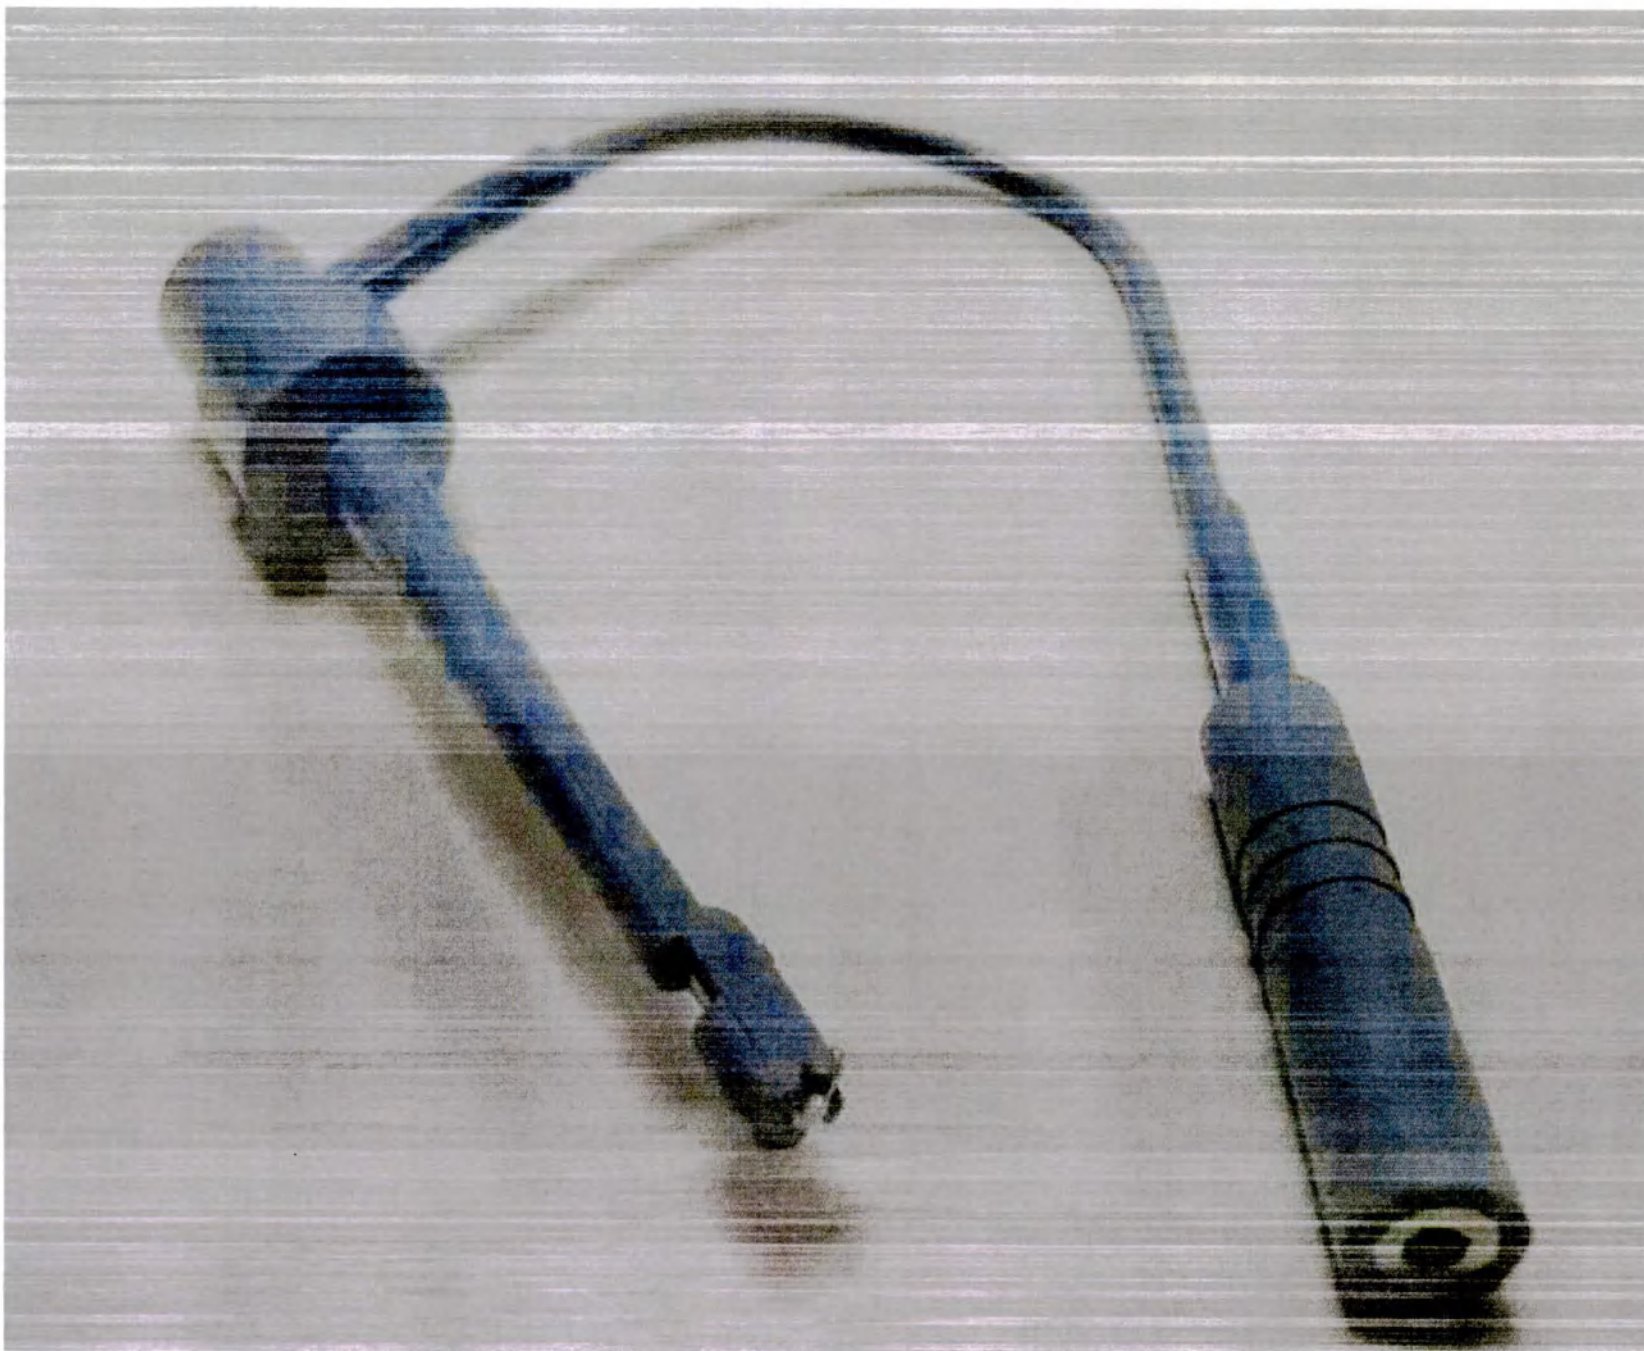


Фотографическое изображение 73 – Файл-клип



Фотографическое изображение 74 – Потребительская упаковка

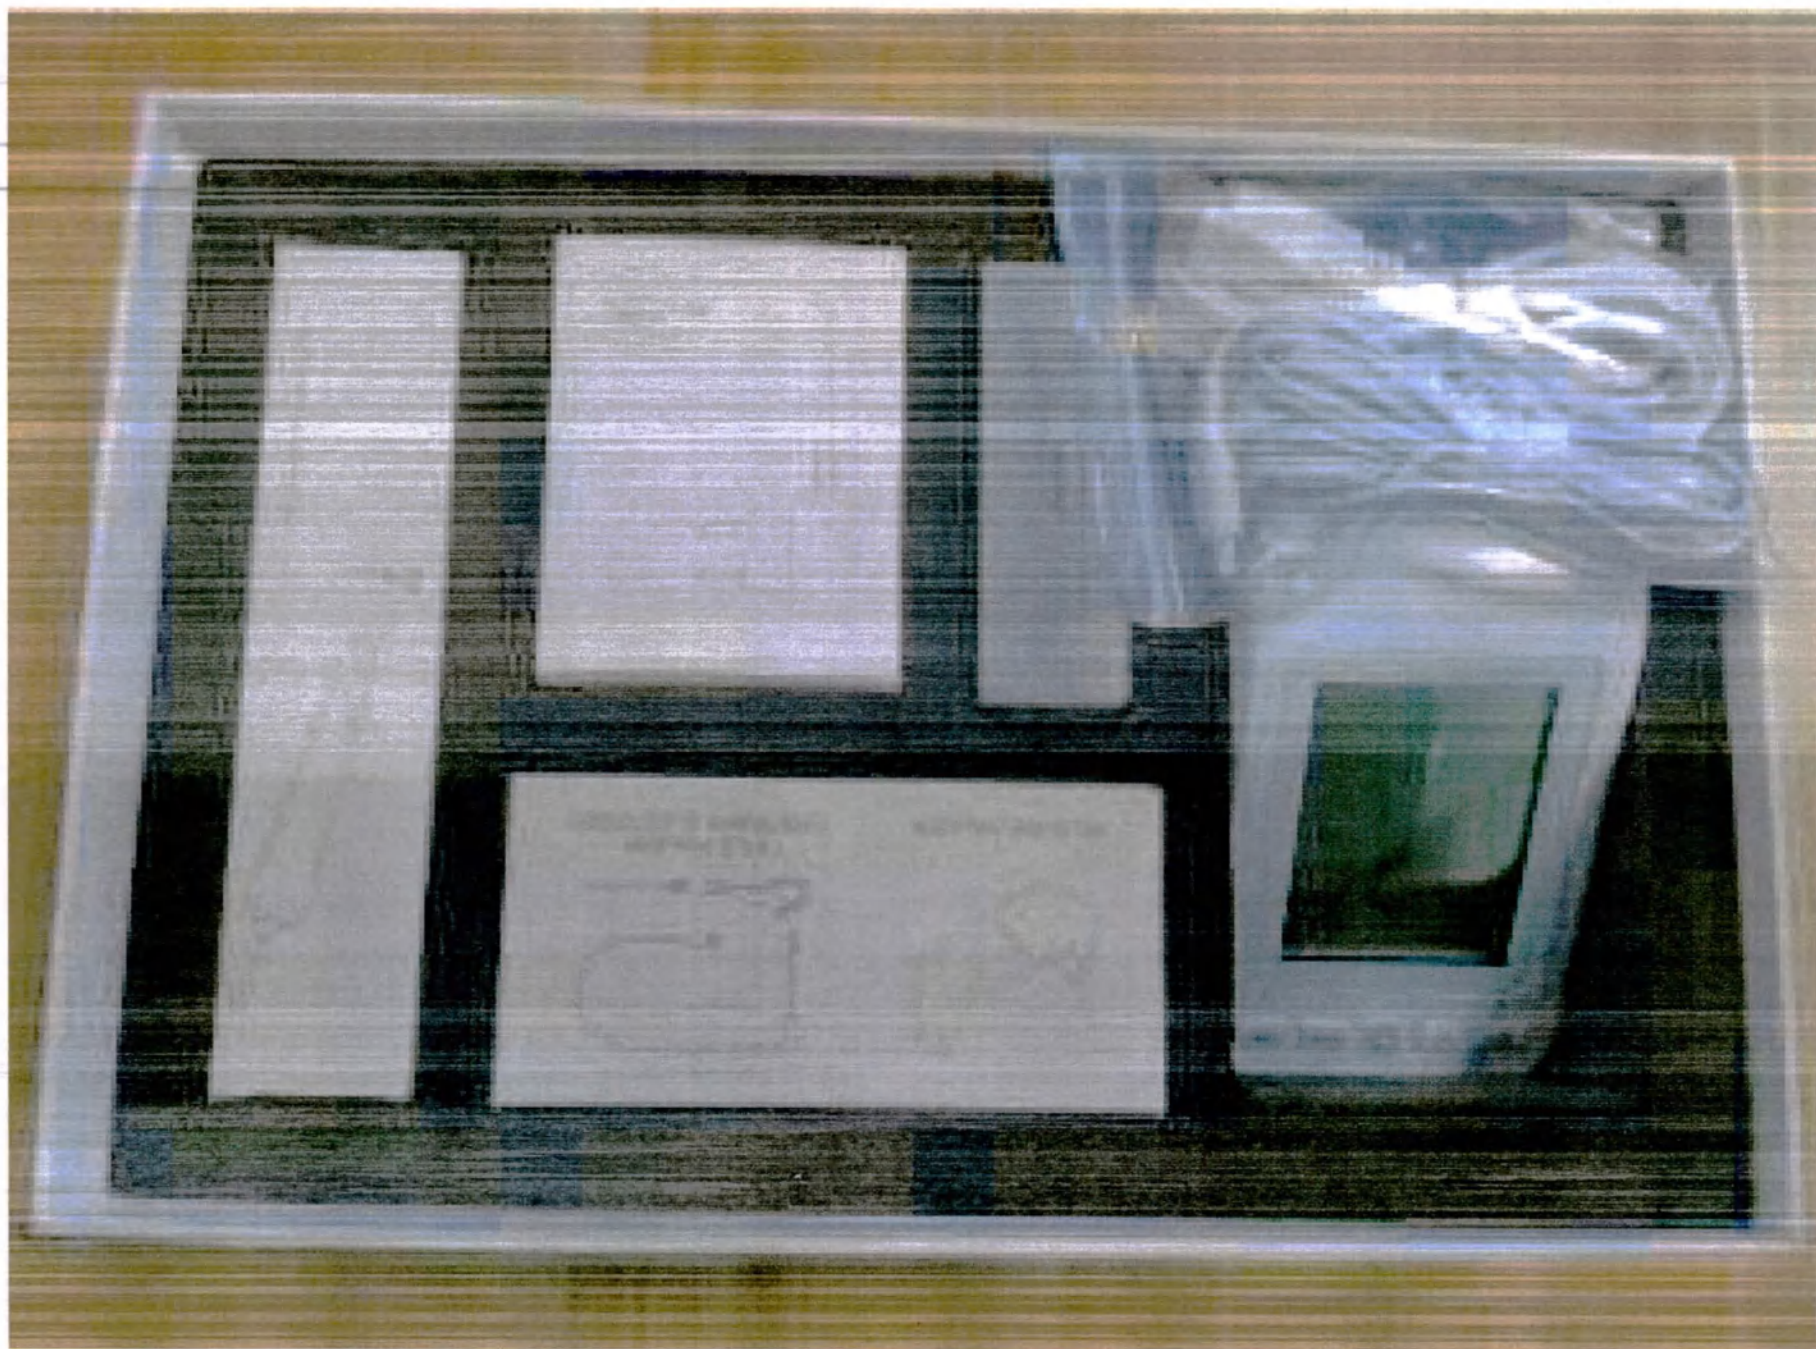

Фотографическое изображение 75 – Потребительская упаковка

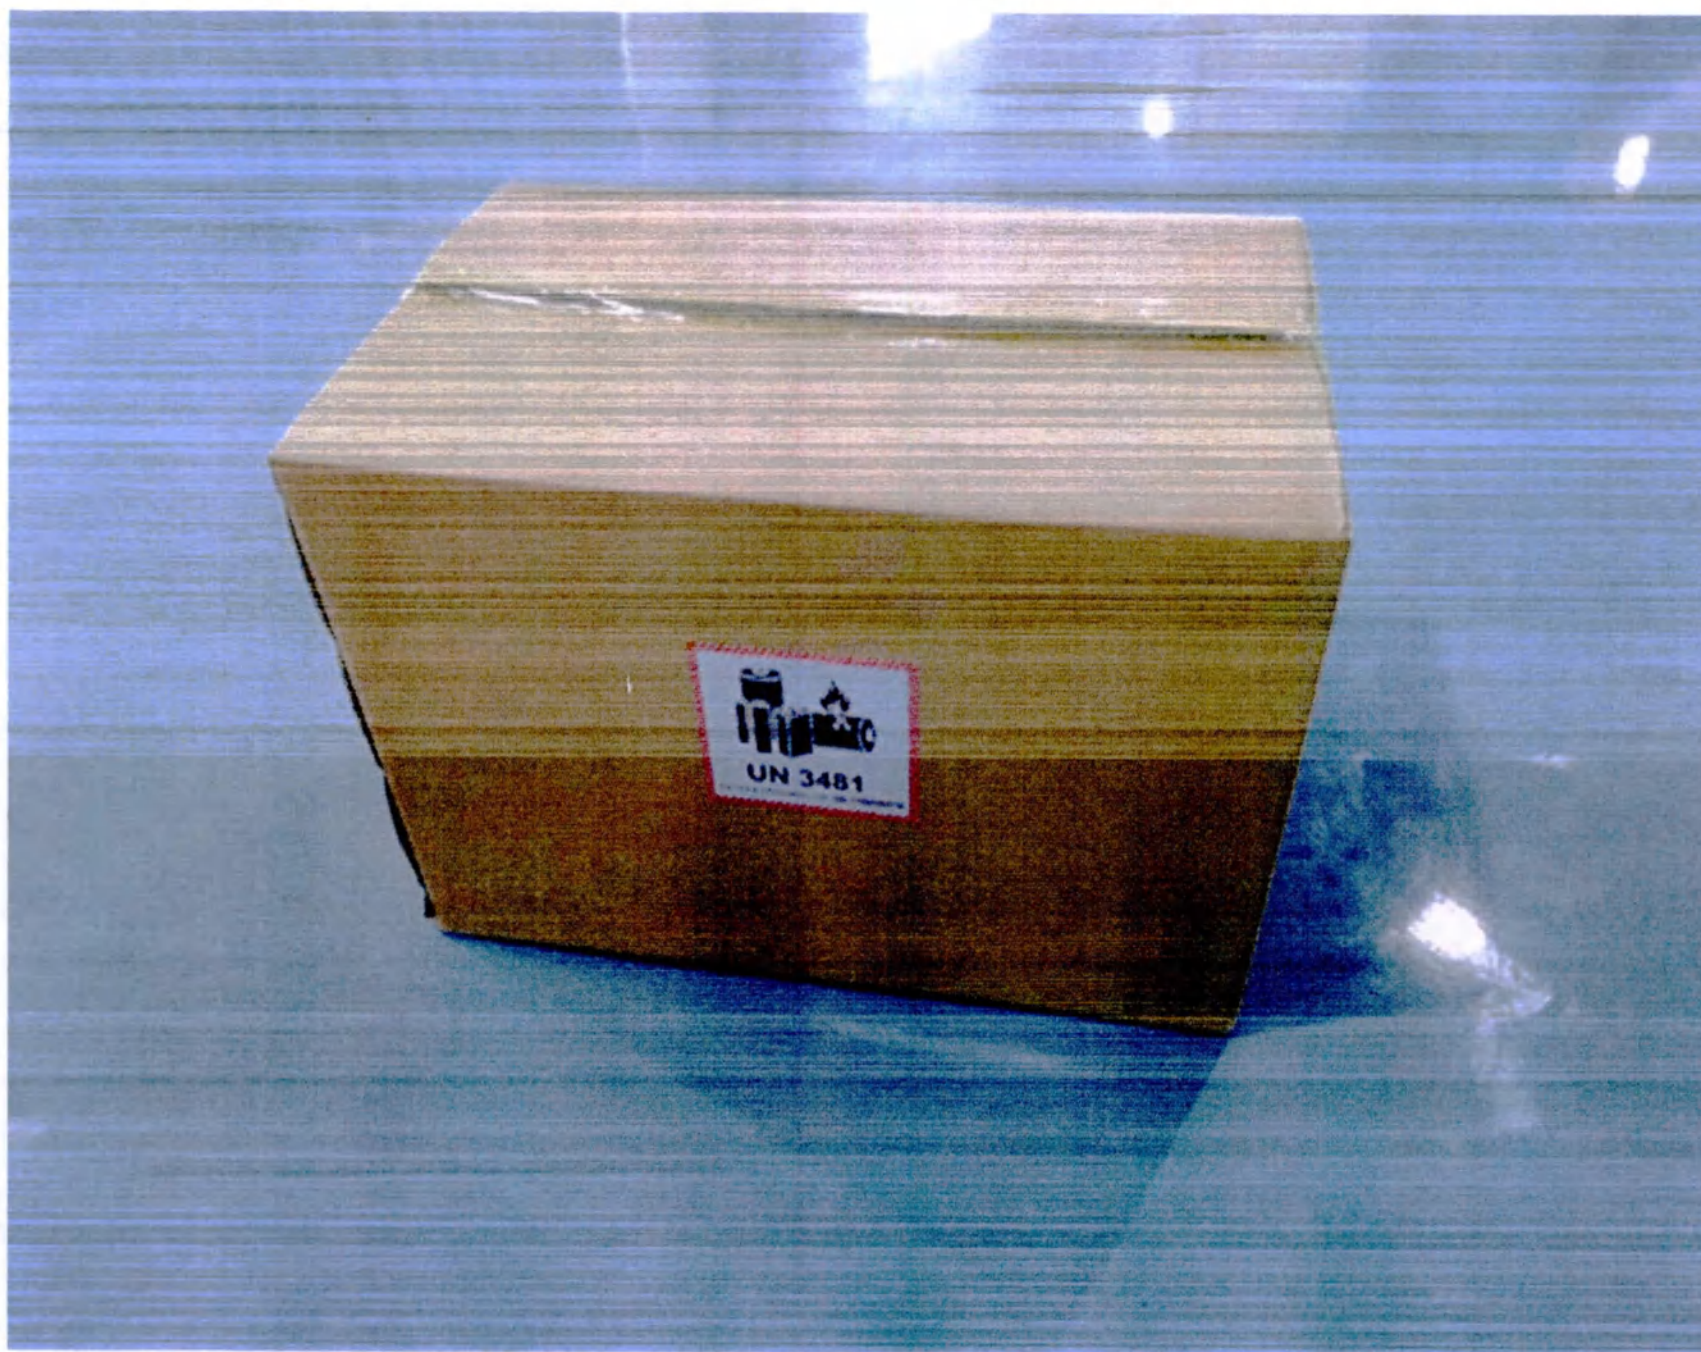

Фотографическое изображение 76 – Транспортная упаковка



Фотографическое изображение 77 – Транспортная упаковка

4. Маркировка изделий

Эндомотора

Эндомотор беспроводной, ZR Touch New Generation

На изделие наносится следующая информация:

- торговая марка изделия;
- наименование модели
- символ «серийный номер»;
- кнопки управления;



Макет маркировки 1 – Эндомотор беспроводной, ZR Touch New Generation

Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором

На изделие наносится следующая информация:

- торговая марка изделия;
- наименование модели
- символ «серийный номер»;
- кнопки управления;



Макет маркировки 2 – Эндомотор беспроводной со встроенным апекслокатором

Эндомотор проводной с апекслокатором

На изделие наносится следующая информация:

- торговая марка изделия;
- символ «серийный номер»;



Макет маркировки 3 – Эндомотор проводной с апекслокатором

Моторный наконечник

На изделие наносится следующая информация:

- торговая марка изделия;
- символ «серийный номер»;
- кнопки управления;



Макет маркировки 4 – Моторный наконечник

Контругловой наконечник

Наносится методом оттилка следующая информация:

- торговая марка изделия (при необходимости);
- серийный номер;
- номер модели;
- передаточное отношение;




Макет маркировки 5 – Контругловой наконечник, модель E-BCA11-A



Макет маркировки 6 – Контругловой наконечник, модель E-X61CA-A

Адаптер питания

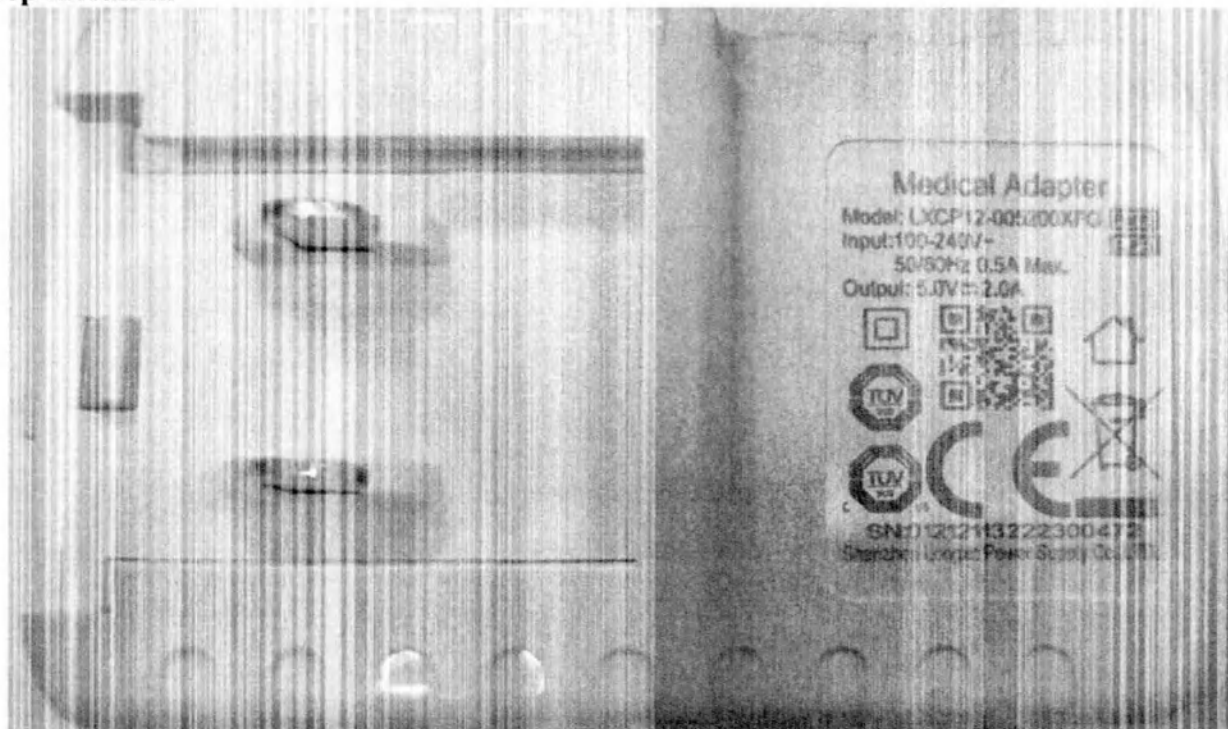

Макет 7 – Маркировка адаптера питания

где


	Русский язык
Medical adapner	Медицинский источник питания
Model	Модель
Input: 100 – 240 V ~50/60Hz 0.5 A Max	Ввод: 100 – 240 В ~50/60 Гц 0.5 А макс
Output: 5V==2.0A	Выход: 5 В == 2,0 А
QR-код	Ссылка на сайт производителя
Символ	«Класс II защиты от поражения электрическим током» «Безопасность»; «Сертификат RoHS»; «Линейная плата питания»; «Соответствие требованиям CE»; «Соответствие ИСО»; «Особая утилизация»;

Маркировка упаковки


Маркировка на изделиях может быть выполнена следующими способами: наклеиванием этикеток или методом типографии.

Заводская маркировка упаковка комплектующих и принадлежностей


На упаковку комплектующих и принадлежностей наносится наименование изделий внутри

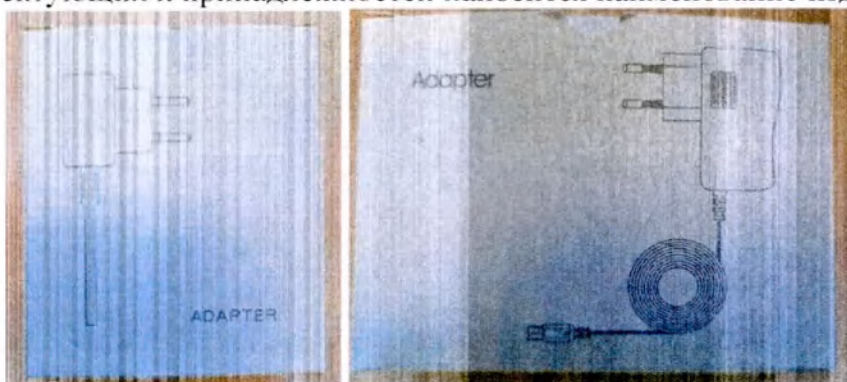

Макет 8 – Маркировка упаковки адаптера питания

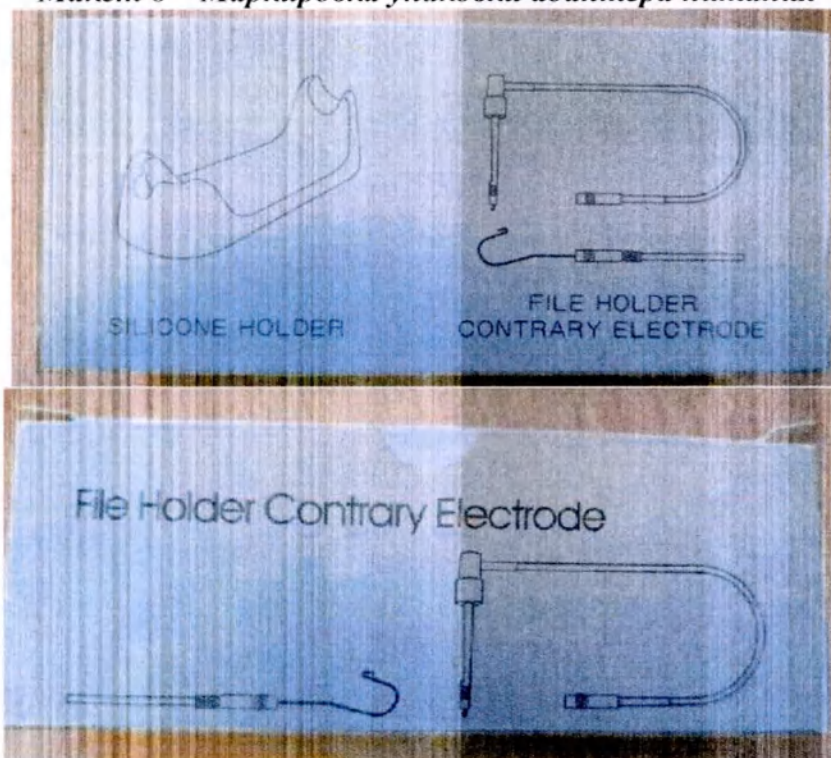

Макет 9 – Маркировка упаковки принадлежностей

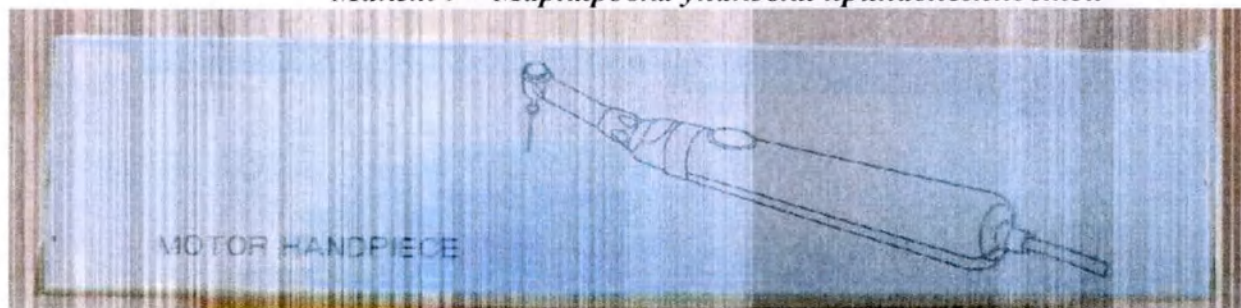

Макет 10 – Маркировка упаковки Эндомотора проводного

Маркировка упаковки комплектующих и принадлежностей для потребителей РФ

На упаковку комплектующих дополнительно наносится этикетка со следующей информацией:

- наименование изделия;
- наименование модели;
- наименование комплектующего;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»


Эндомотор для препарирования корневых каналов

Модель эндомотора: _____

Комплектующее: _____



Заводская маркировка упаковка эндомотора

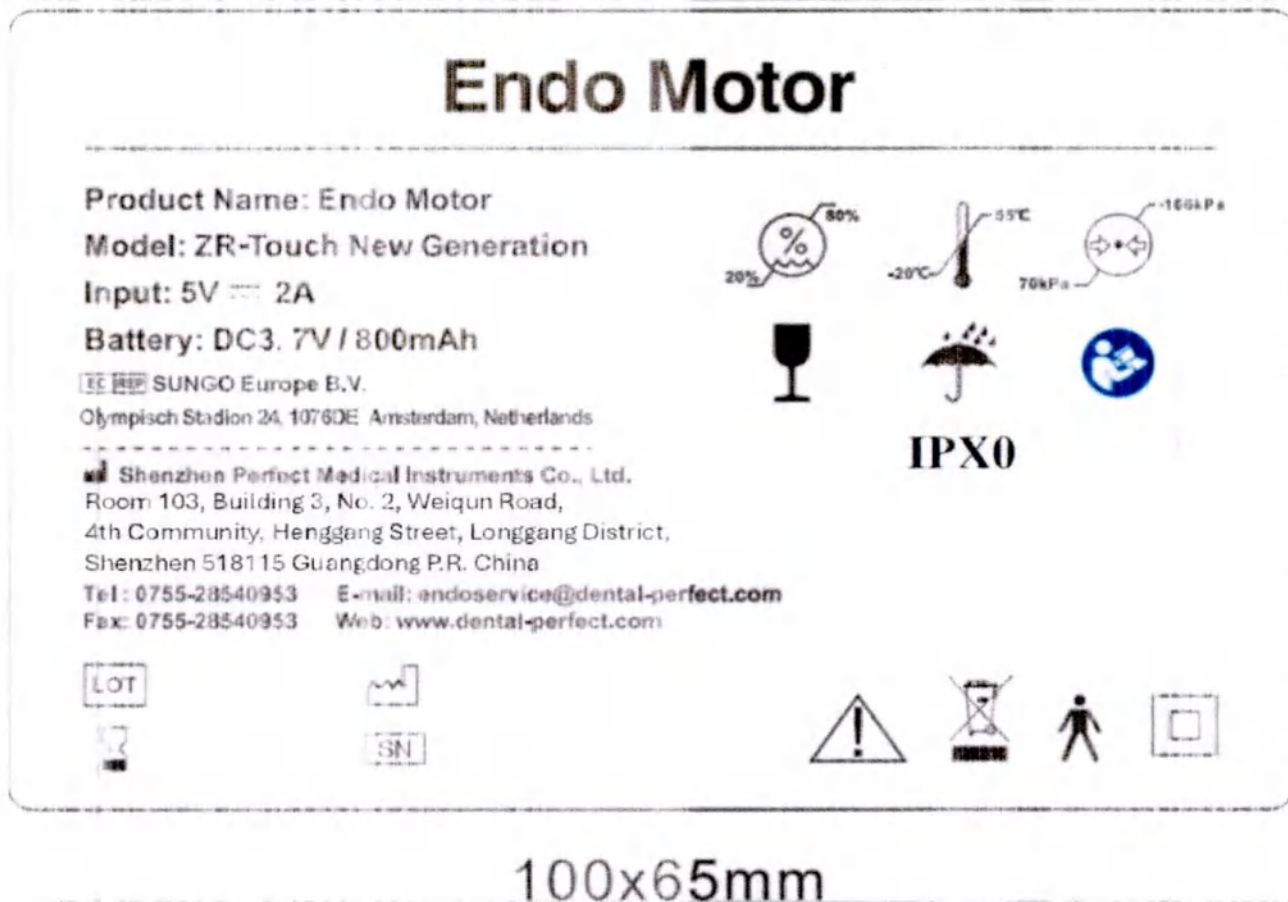

100x65mm

Макет 11 – Макет заводской маркировки, модели ZR Touch New Generation

Endo Motor

Product Name: Endo Motor

Model: ZR-Touch New Generation

Input: 5V 2A

Battery: DC3.7V / 800mAh

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands


Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd.
Room 103, Building 3, No. 2, Weiqun Road,
4th Community, Henggang Street, Longgang District,
Shenzhen 518115 Guangdong P.R. China

Tel: 0755-28540953



E-mail: endoservice@dental-perfect.com

Fax: 0755-28540953

Web: www.dental-perfect.com

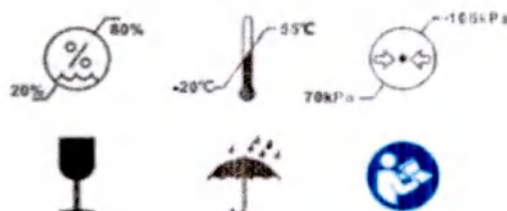

IPX0



100x65mm

Макет 12 – Макет заводской маркировки, модели ZR-Rap

Endo Motor

Product Name: Endo Motor

Model: ZR-Touch New Generation

Input: 5V 2A

Battery: DC3.7V / 800mAh

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands


Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd.
Room 103, Building 3, No. 2, Weiqun Road,
4th Community, Henggang Street, Longgang District,
Shenzhen 518115 Guangdong P.R. China

Tel: 0755-28540953



E-mail: endoservice@dental-perfect.com

Fax: 0755-28540953

Web: www.dental-perfect.com

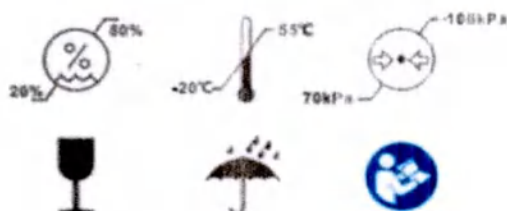

IPX0



100x65mm

Макет 13 – Макет заводской маркировки, модели MR-Auto-Motor

**Эндомотор
для препарирования корневых каналов**

Наименование : _____

Модель : _____

Вход : _____

Аккумулятор : _____

Шенжен Перфест Медисал Инструменте Со., Лтд.

Офис 103, Здание 3, № 2, Вэйшюнь роуд, 4-й микрорайон, улица
Хэнган, район Лунган, Шэньчжэнь 518115, провинция Гуандун,
Китай

Уполномоченный представитель в Российской Федерации

ООО «Еврофайл»
115230, город Москва, Варшавское ш., д. 46, стр. 6
Тел.: +7 (495) 540-58-95, E-mail: info@eurofiles.ru

IPX0



LOT _____

SN _____

Макет 14 – Макет заводской маркировки на русском языке

Используемые символы

Символ	Обозначения
	Ограничения влажности
	Температурные ограничения
	Ограничения атмосферного давления
	Хрупкое
	Беречь от влаги
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель изделия
	Код партии
	Маркировка года и месяца изготовления аппарата
	Серийный номер
	Использовать до
	Класс II защиты от поражения электрическим током
	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа В
	Особая утилизация

Символ	Обозначения
	Обращаться с осторожностью
	Постоянный ток
DC	Переменный ток
	Литий-Ионные аккумуляторы
	Безопасность
	Соответствие требованиям CE
	Система для квалифицированных испытаний и сертификации электротехнической продукции
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
IPX0	Степень защиты оболочки
	Сертификат RoHS
LPS	Линейная плата питания
	Соответствие ИСО 9001

Пронумеровано 85/восемьдесят пять
прошнуровано, Генеральный директор ООО
"ЕВРОФАЙЛ" Роджабова А.А.

