



ООО «ДжиИ Хэлскеа»

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, дом 10

Т: +7 495 739 6931

ПОДВЕРЖДАЮ



Менеджер программ по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Дорофеева Ю. Н.

от «01» сентября 2024 года

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Установка ангиографическая Innova IGS 5, Innova IGS 6 с принадлежностями»

GE Medical Systems SCS

«ДжиИ Медикал Системз ЭсСиЭс»



Рисунок 1. Установка ангиографическая Innova IGS 5 с принадлежностями (общий вид)

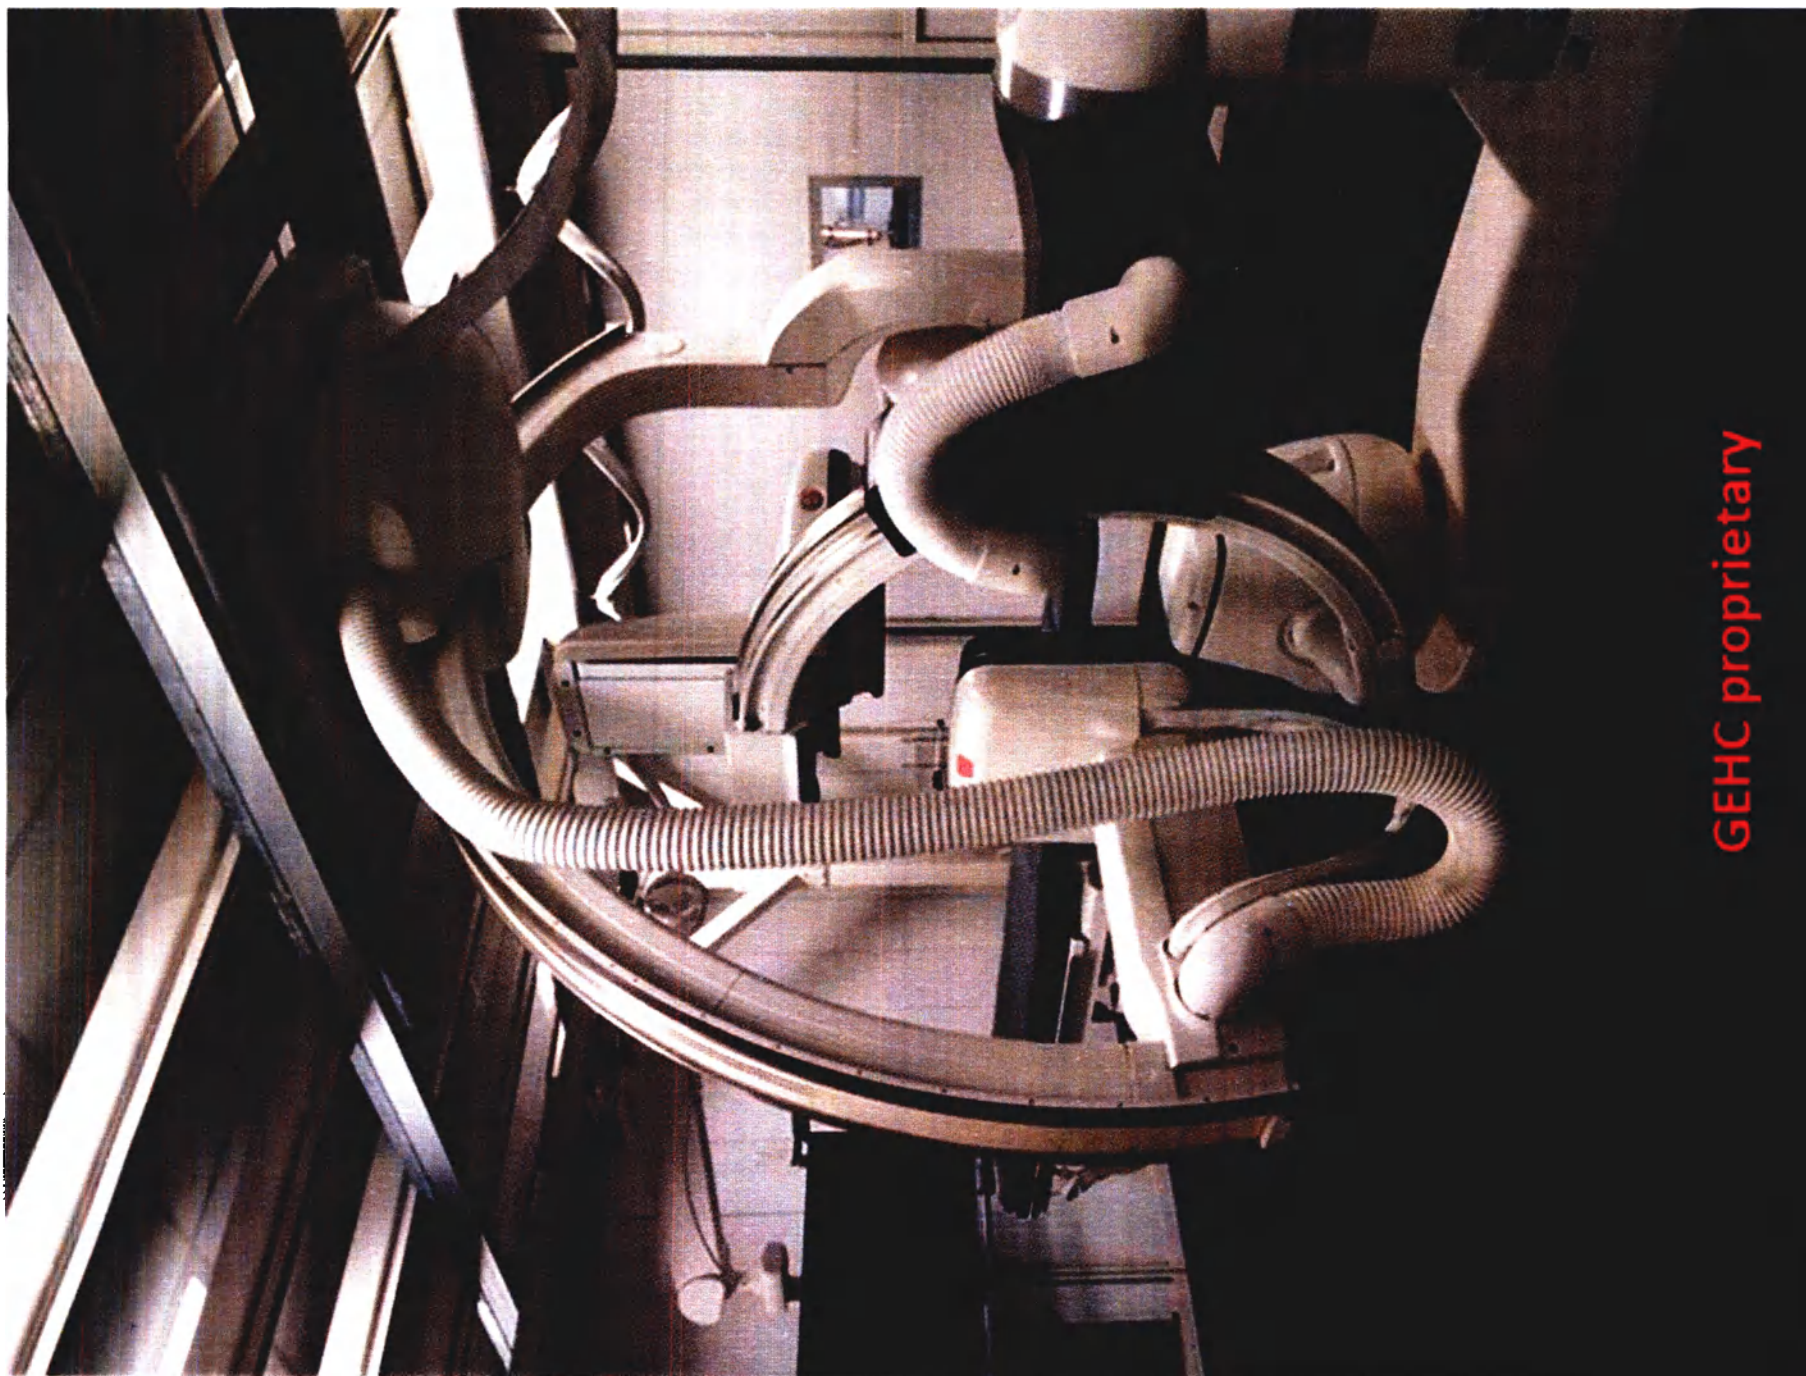


Рисунок 2. Установка ангиографическая Innova IGS 6 с принадлежностями (общий вид)



GENC proprietary

Рисунок 3. Рентгеновская трубка.

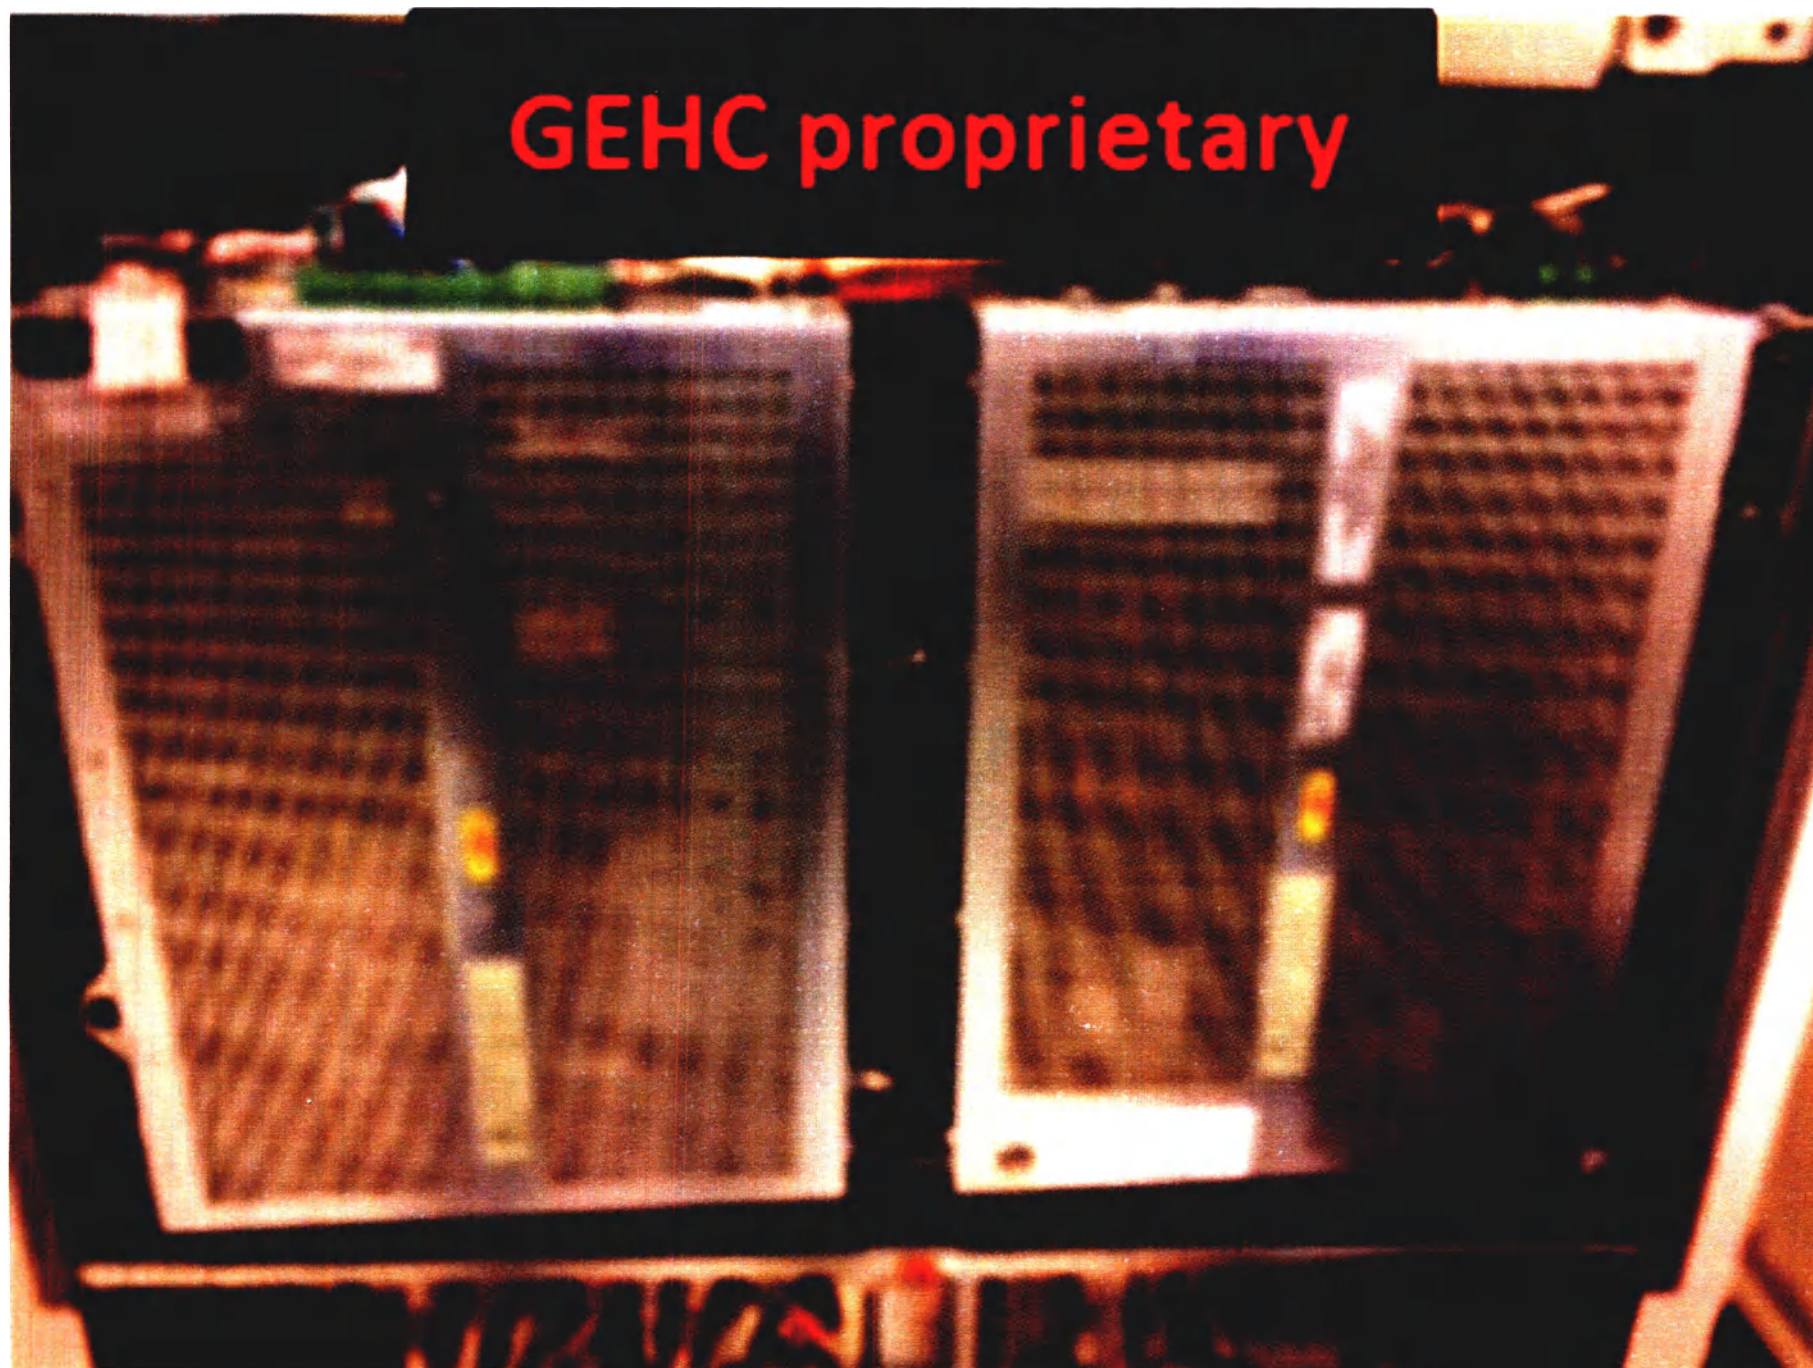


Рисунок 4. Генератор.

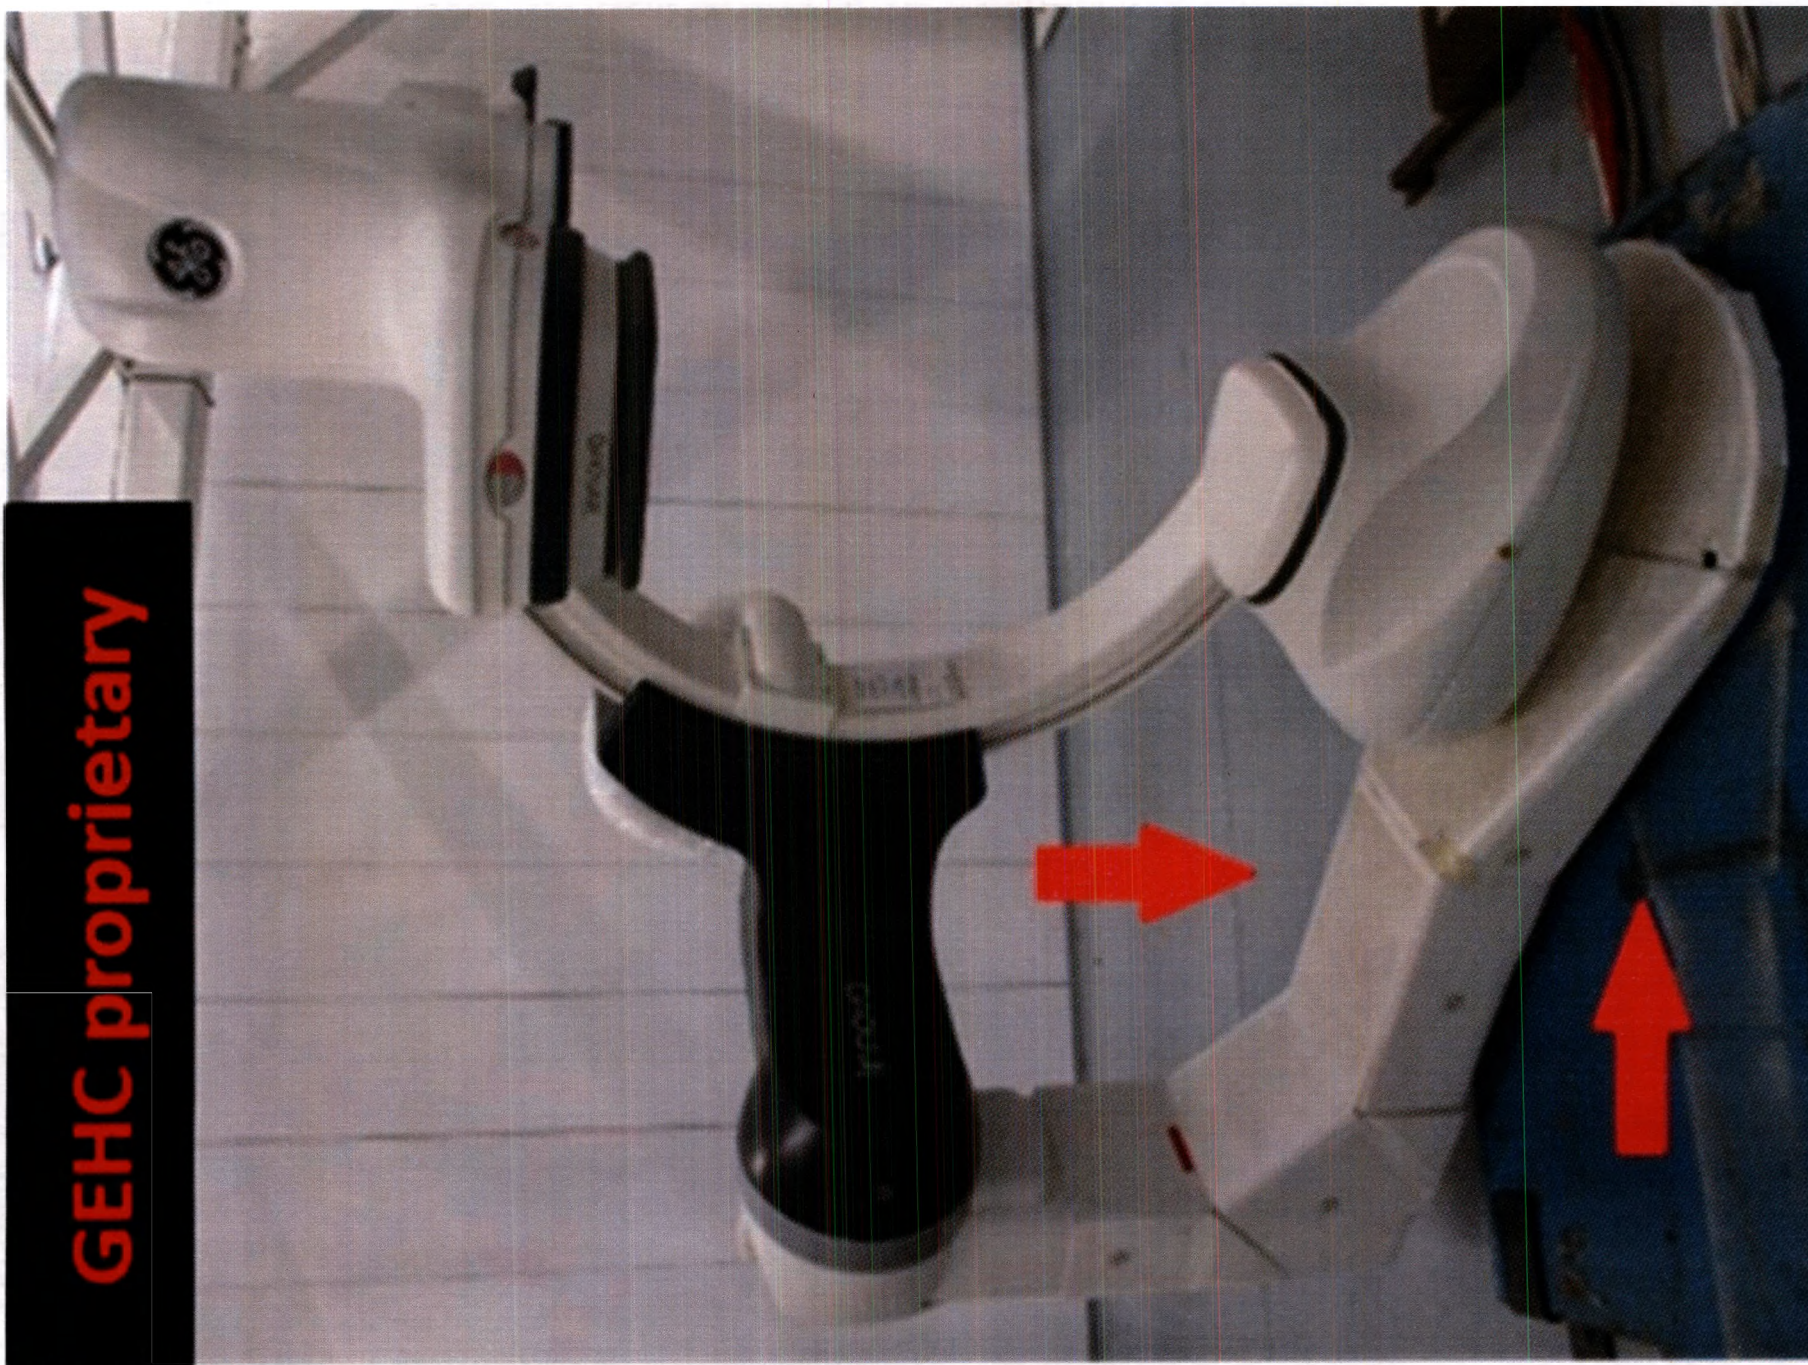


Рисунок 5. Позиционирующее LC-устройство.

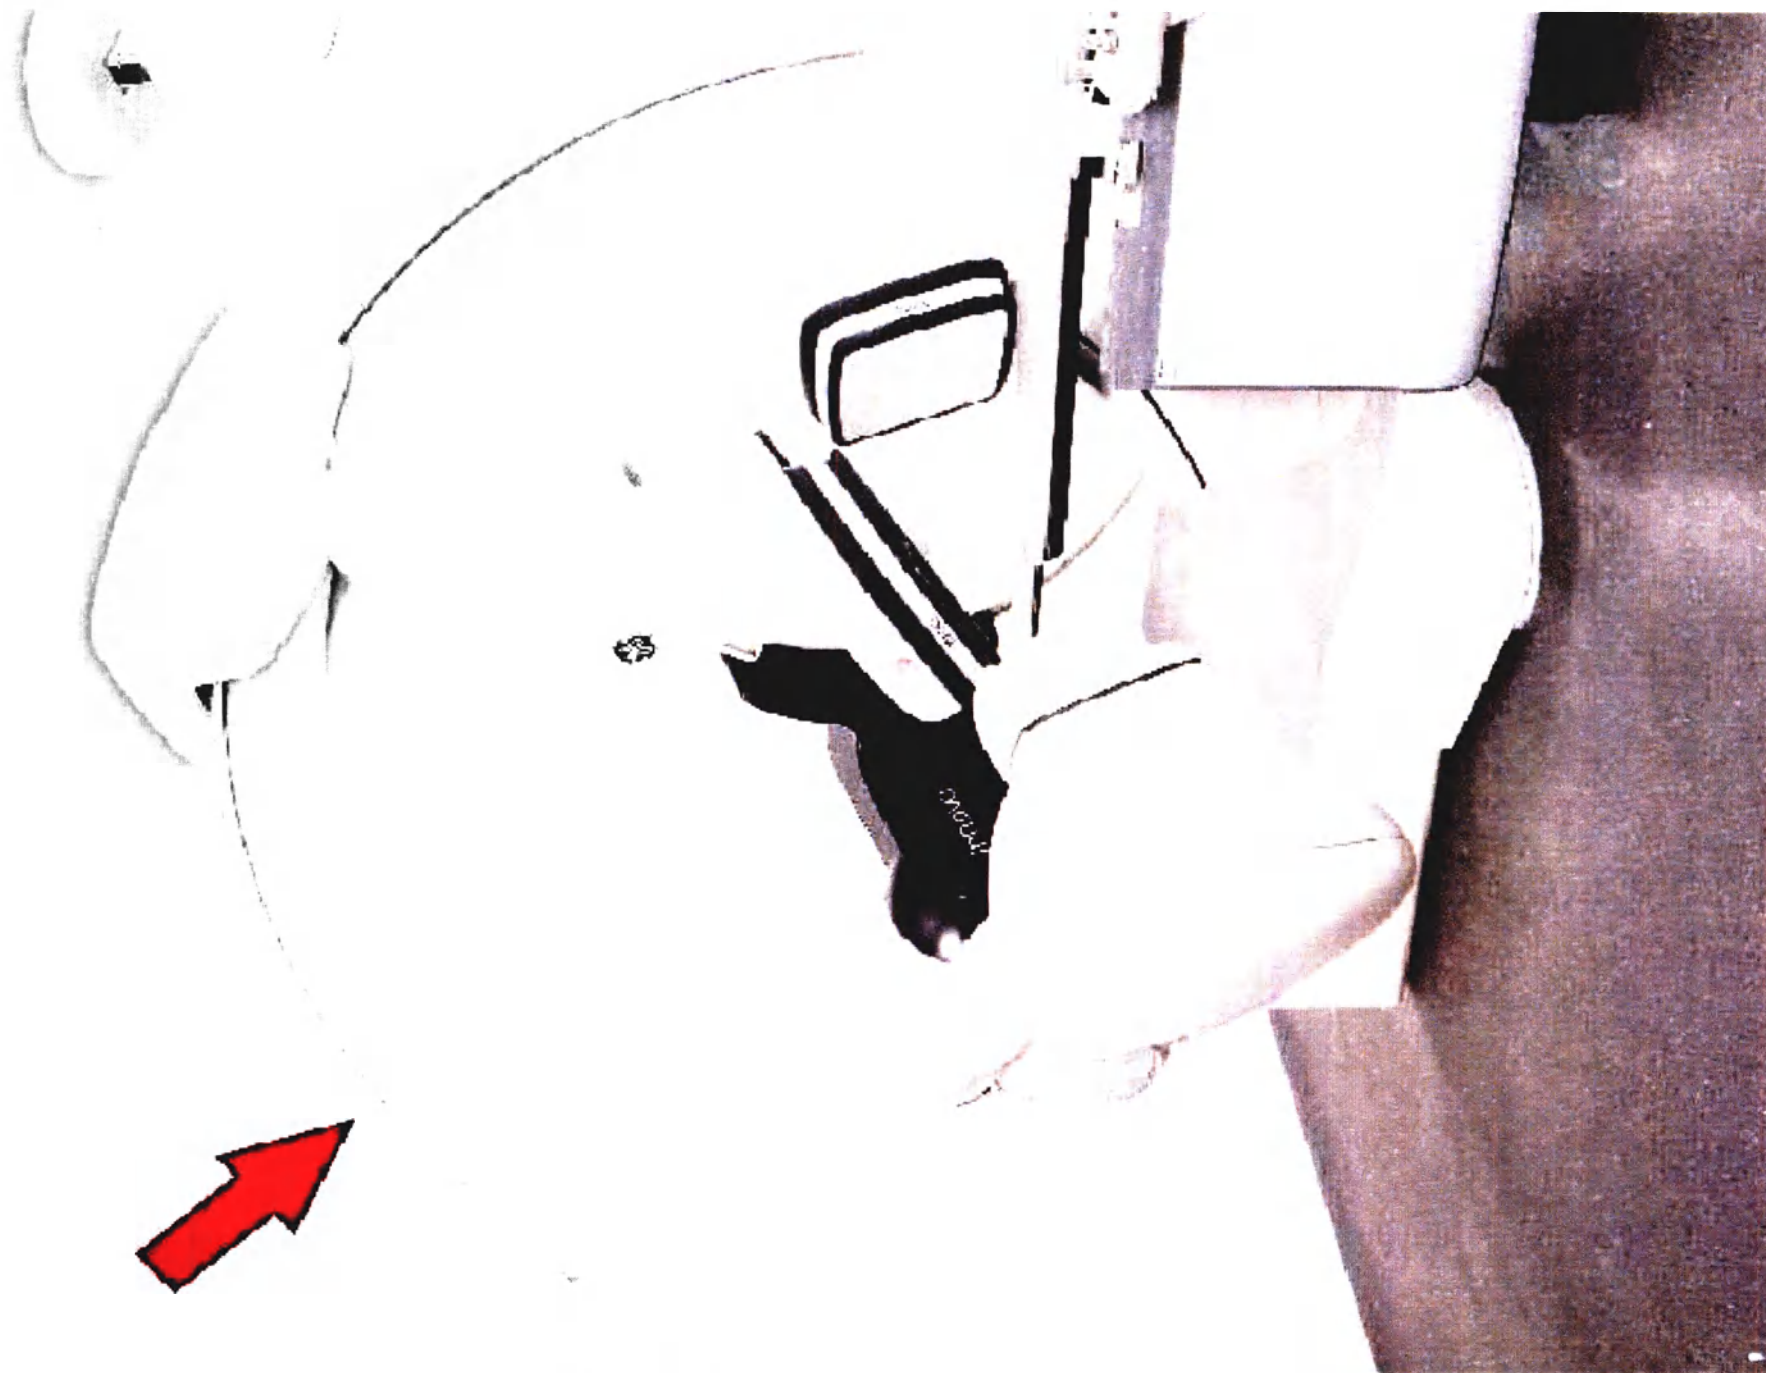


Рисунок 6. Позиционирующее LP-устройство.



Рисунок 7. Цифровой детектор 20.



Рисунок 8. Цифровой детектор 30.



Рисунок 9. Цифровой детектор 40.

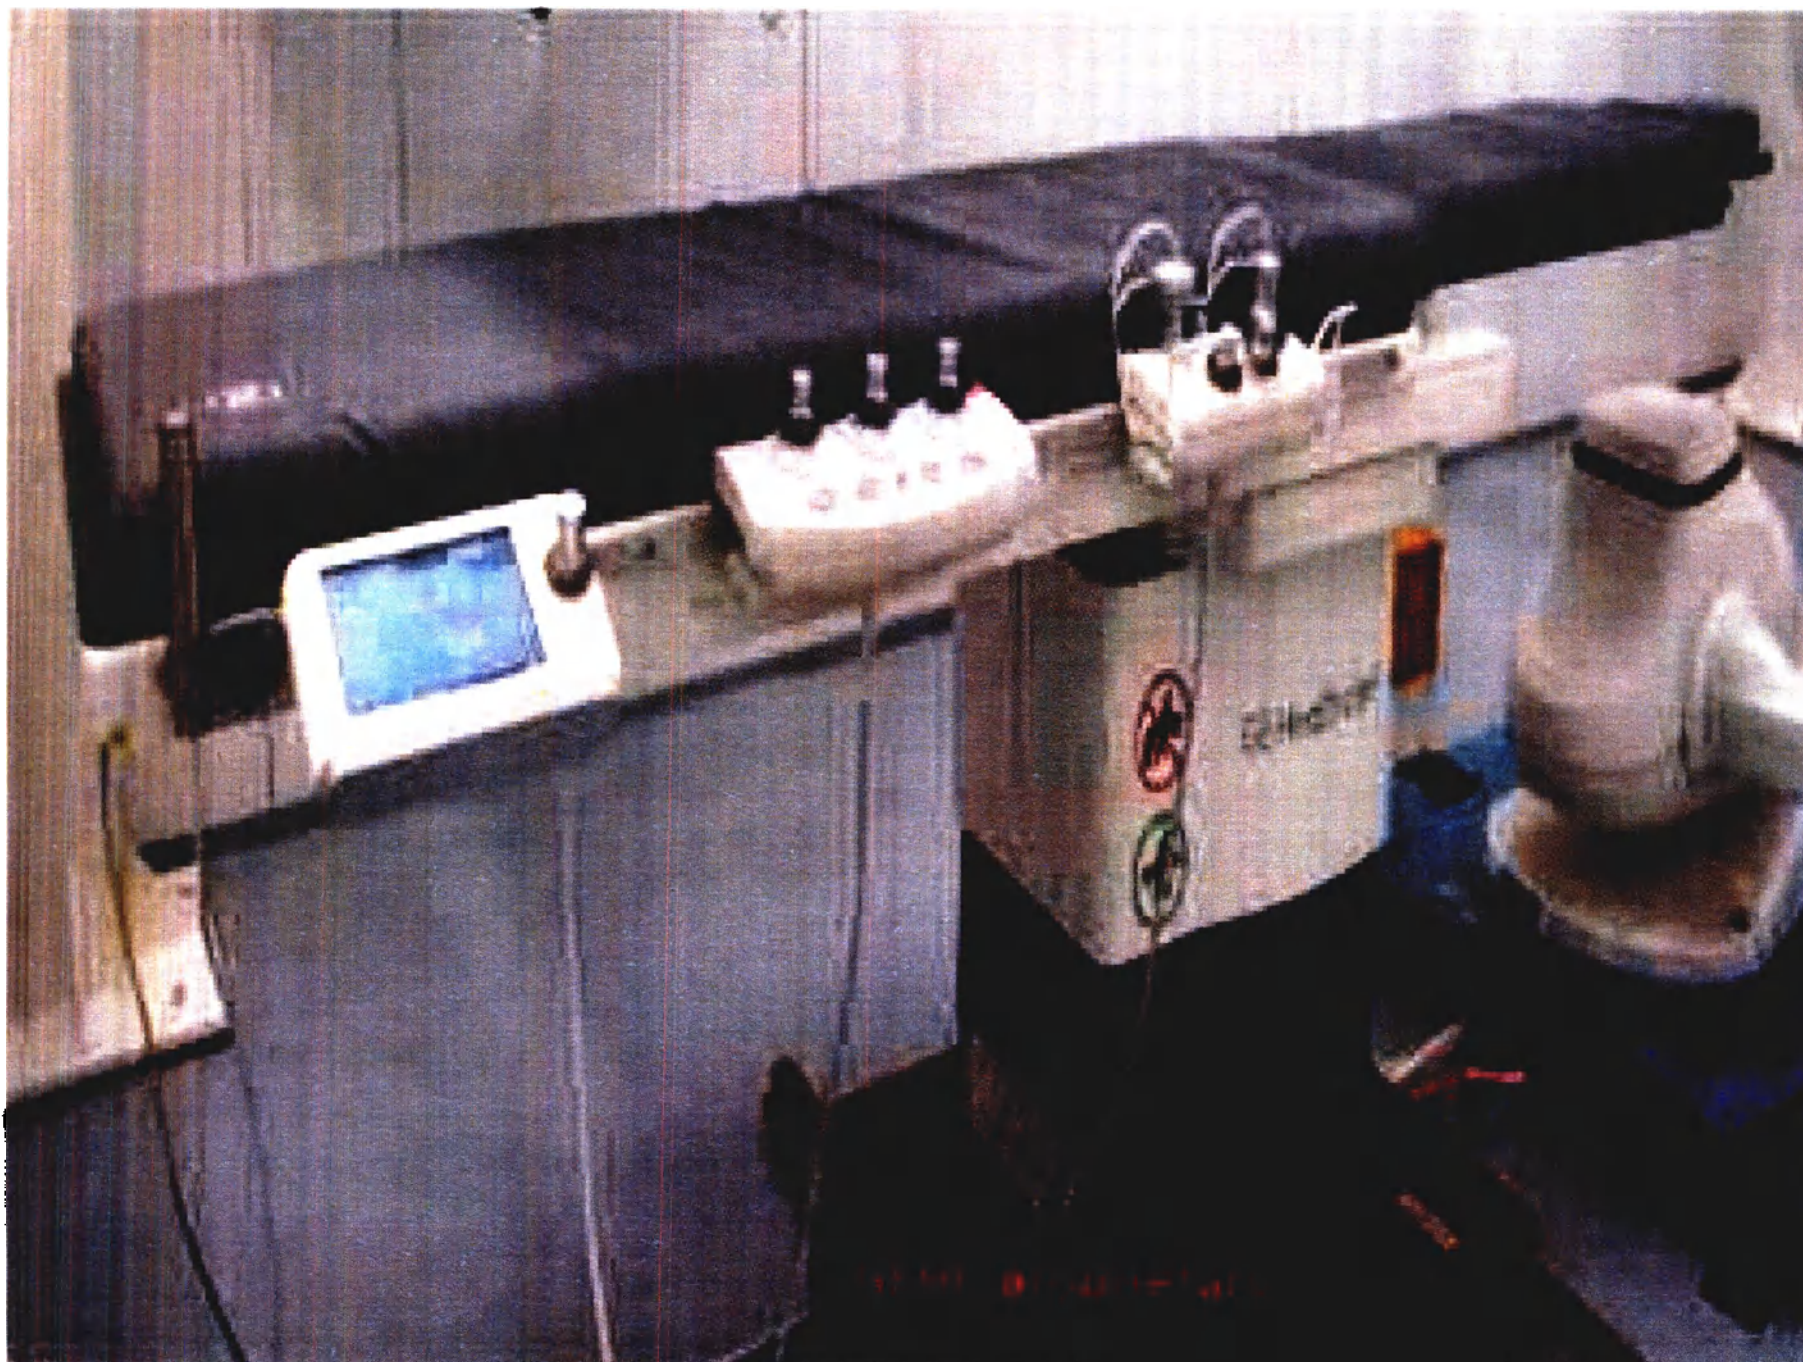


Рисунок 10. Стол ангиографический.



Рисунок 11. Центральный сенсорный экран управления.



Рисунок 12. Удаленная панель управления ангиографической системой, TSSC контроллер.



Рисунок 13. Удаленная панель управления ангиографической системой, держатель дополнительного TSSC в пультовой.

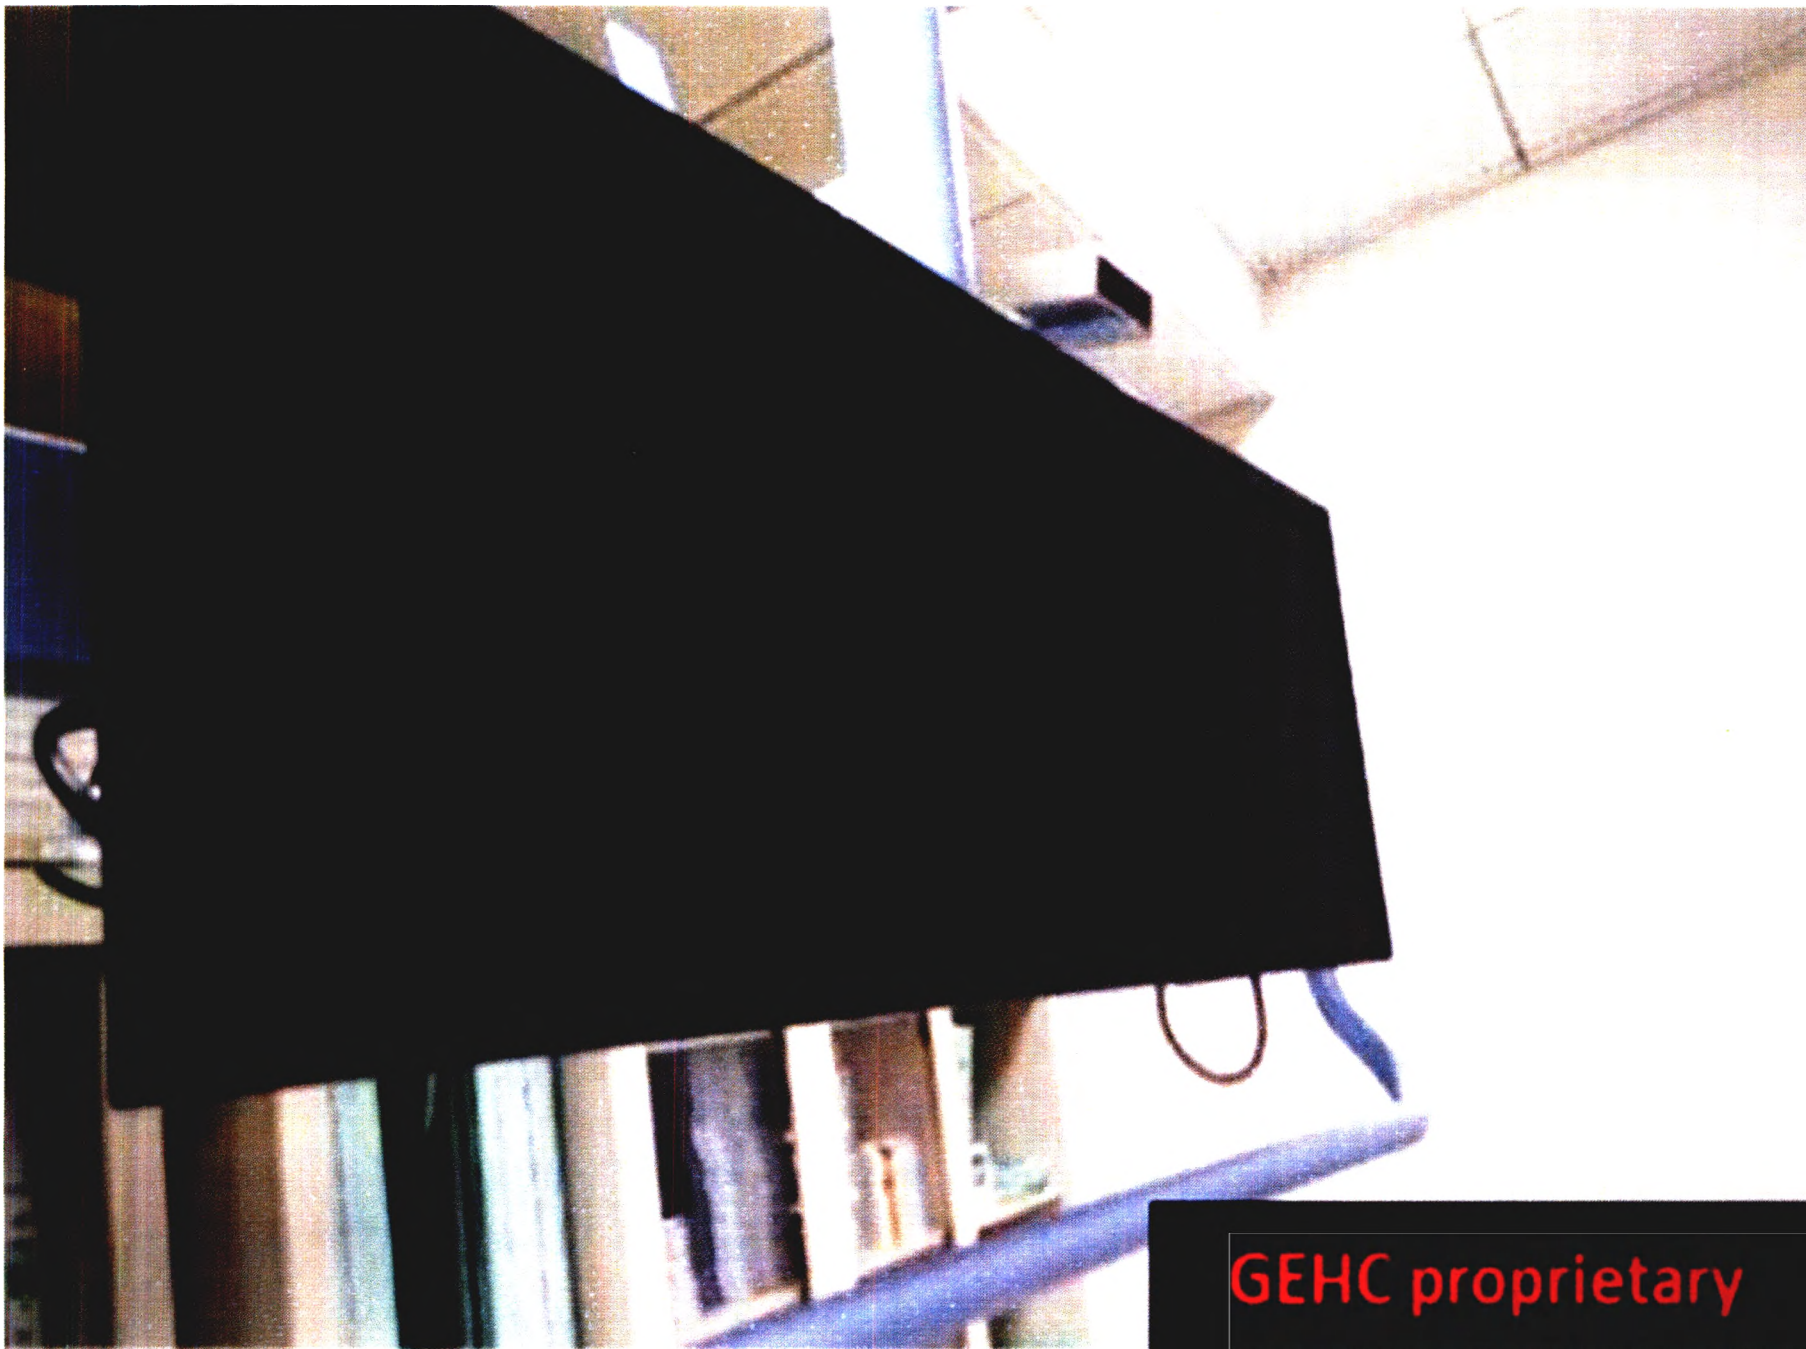


Рисунок 14. Цветные мониторы для вывода мультимодальных изображений.



Рисунок 15. Медицинские мониторы с возможностью организации изображений.



Рисунок 16. Стол ангиографический с опцией наклона.



Рисунок 17. Устройство наклона стола.



Рисунок 18. Хирургический светильник высокой интенсивности с потолочным креплением.



Рисунок 19. Хирургические защитные фартуки.



Рисунок 20. Рентгенозащита для щитовидной железы.

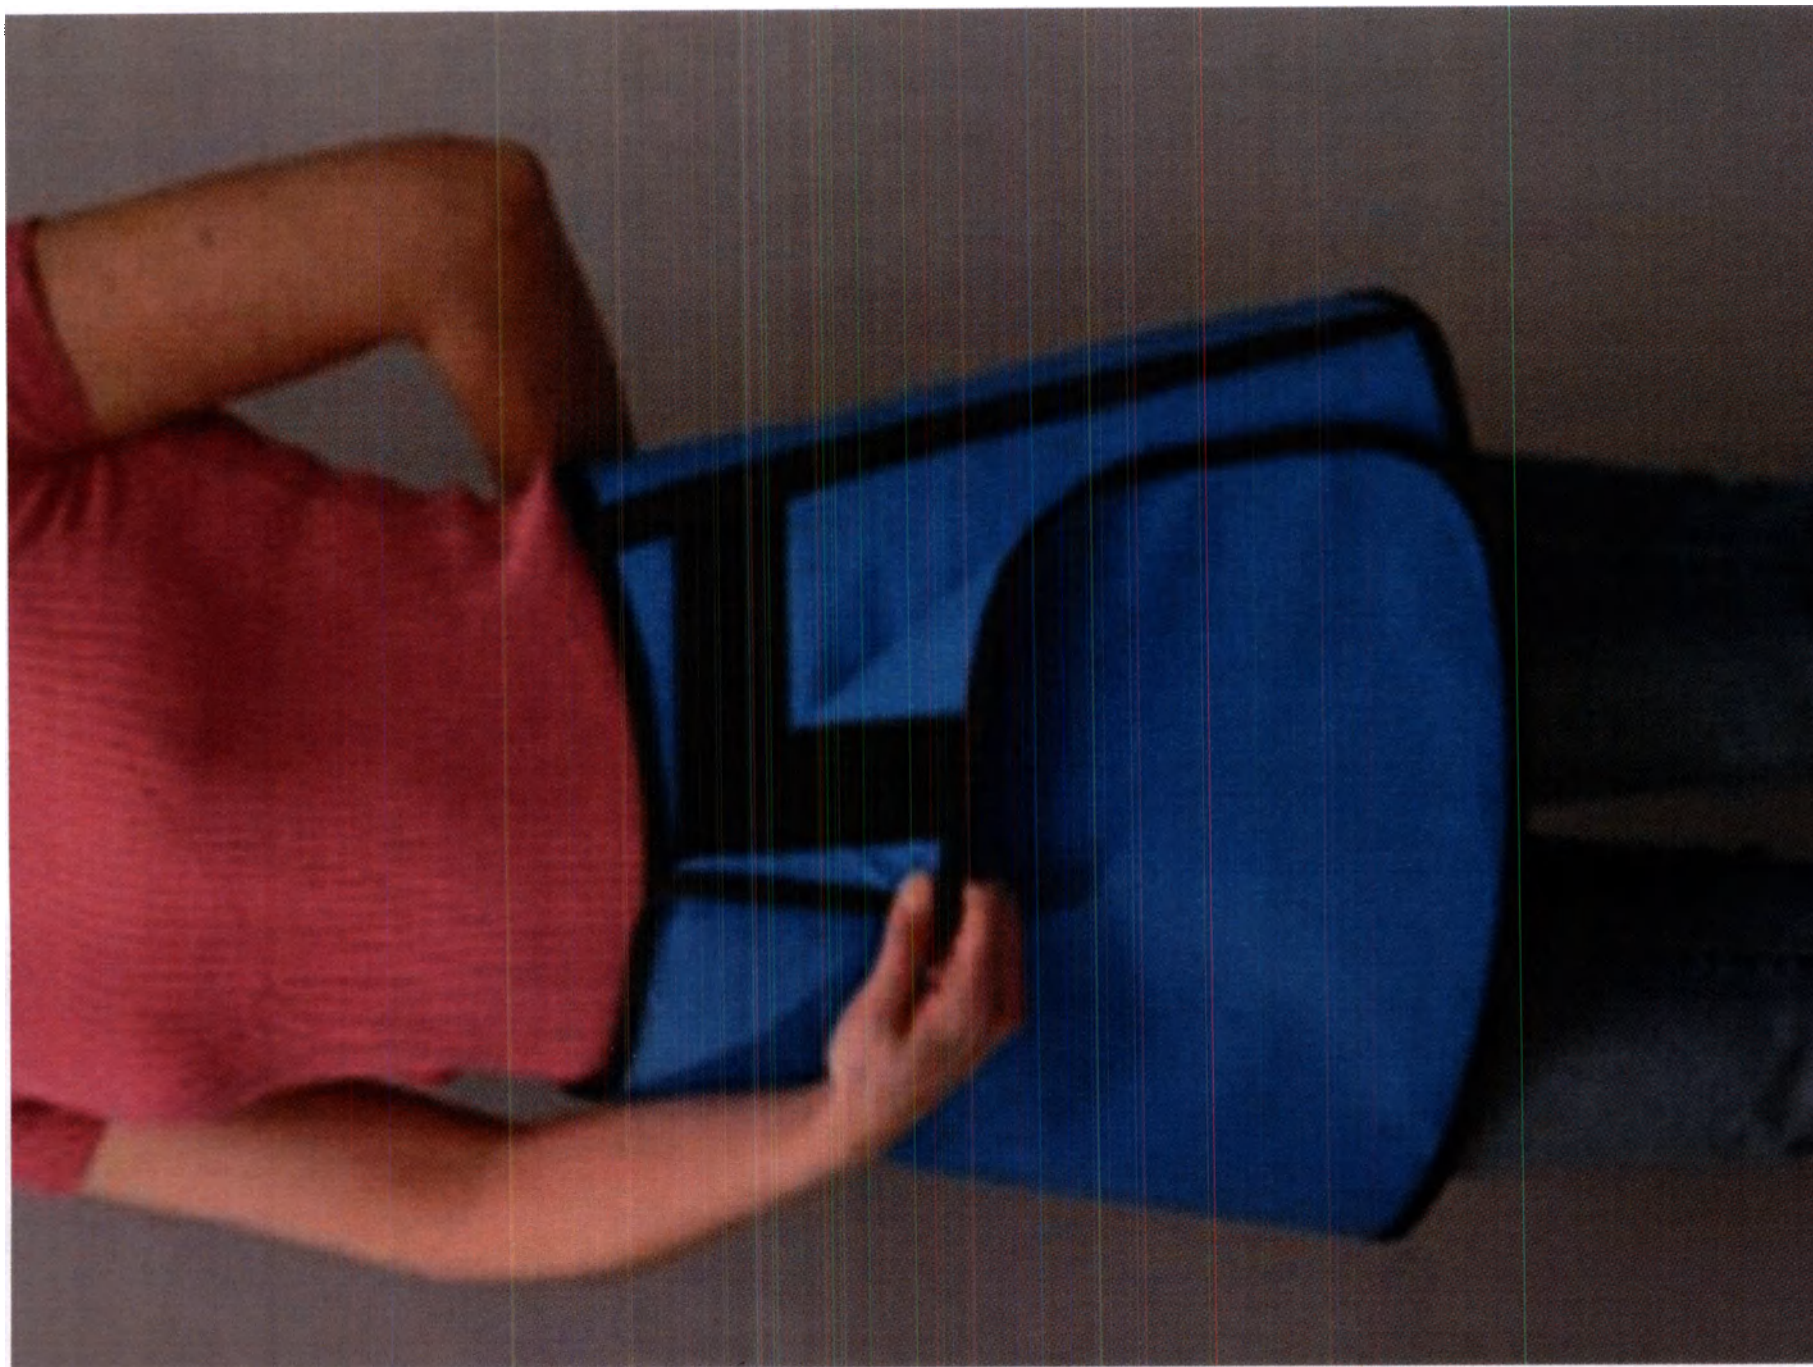


Рисунок 21. Рентгенозащитные юбки.



Рисунок 22. Рентгенозащитные накидки.



Рисунок 23. Защита пациента от рентгеновского излучения.



Рисунок 24. Рентгенозащитные очки.

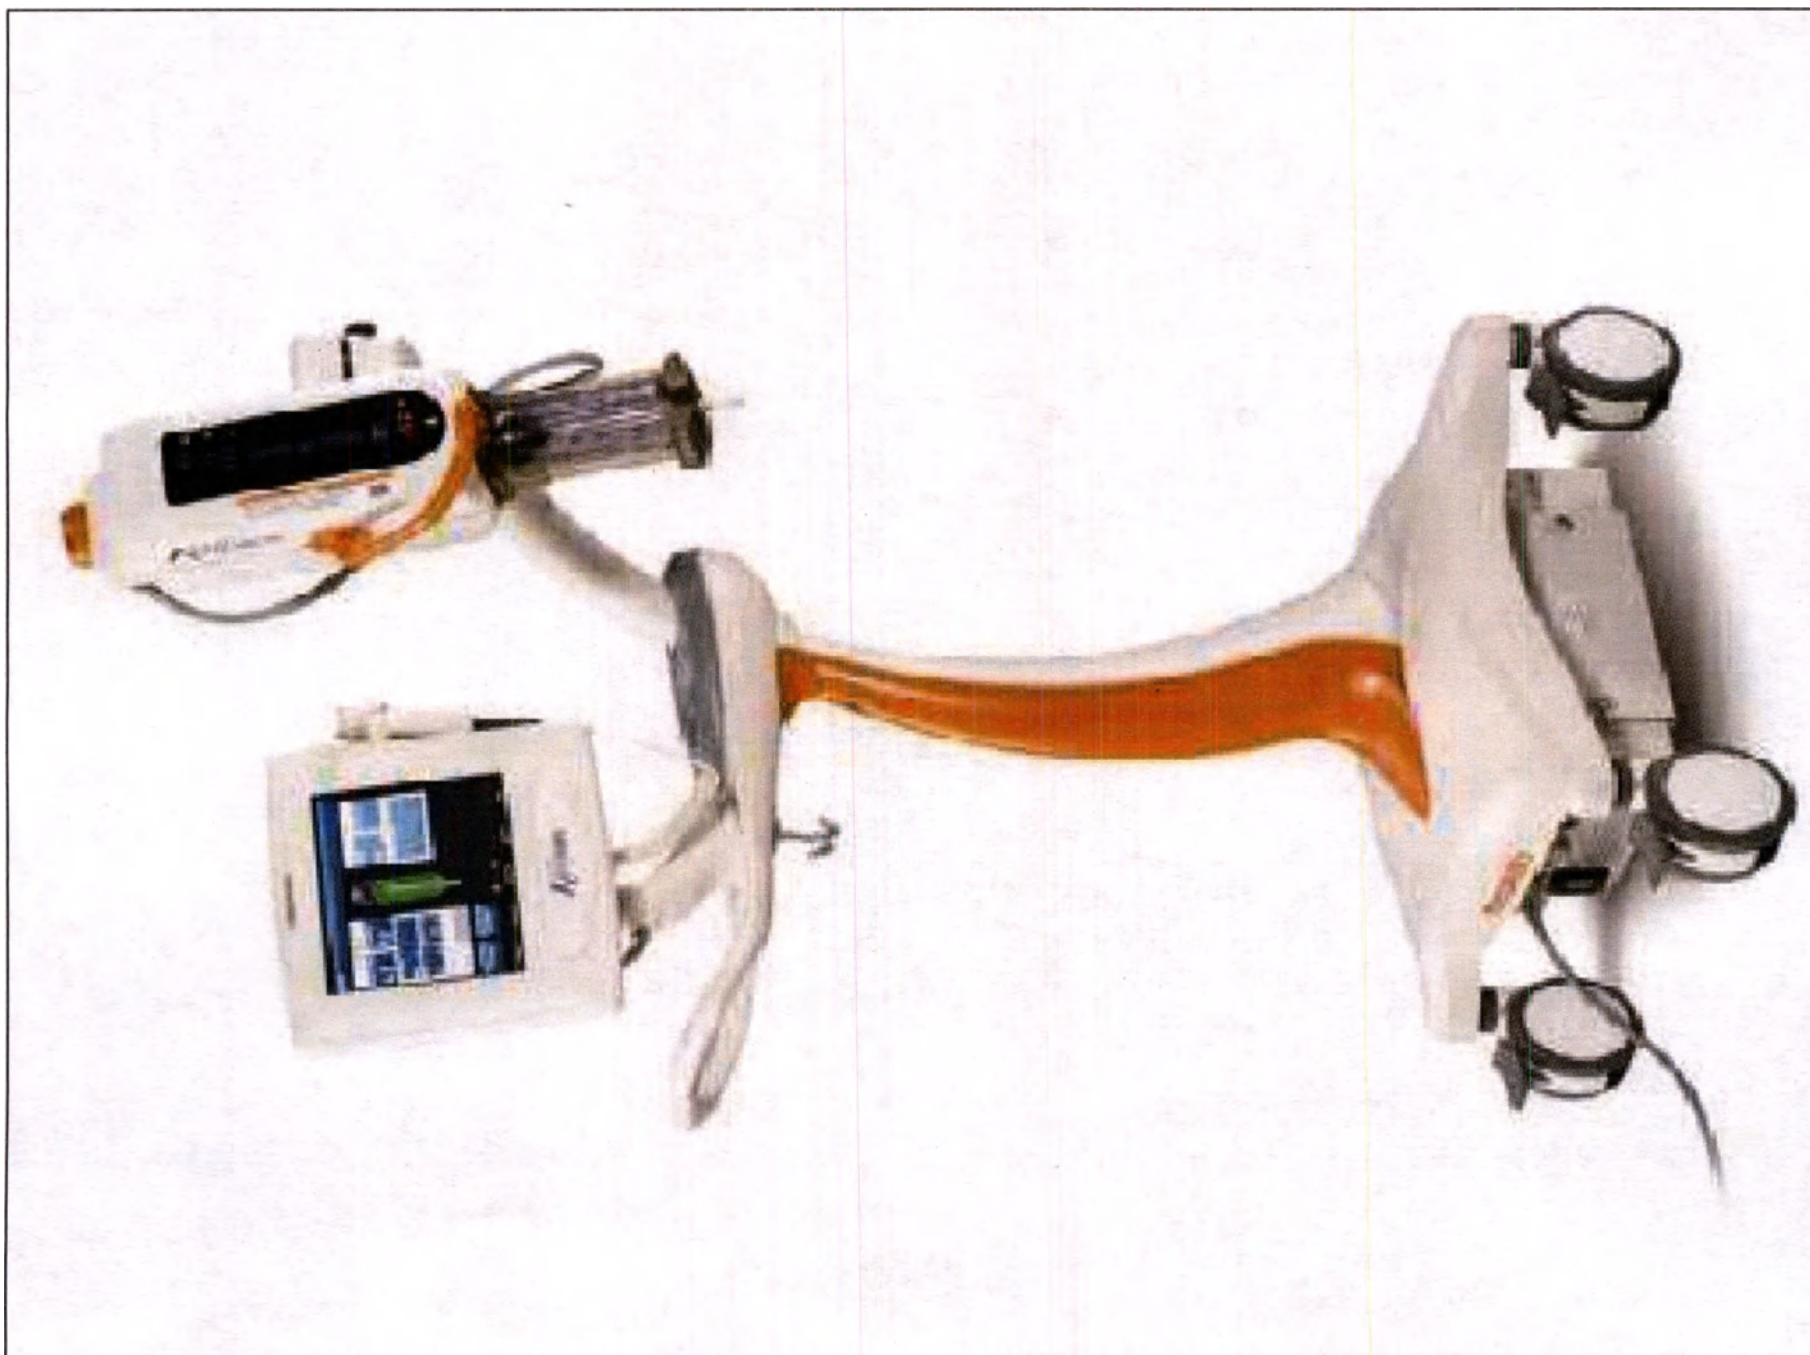


Рисунок 25. Устройства автоматические для введения контрастного вещества.



Рисунок 26. Дозиметрическое устройство Дозиметрическое устройство DIAMENTOR M4 KDK. Цифровой дисплейный блок.



Рисунок 27. Дозиметрическое устройство DIAMENTOR M4 KDK. Дополнительный дисплейный блок.

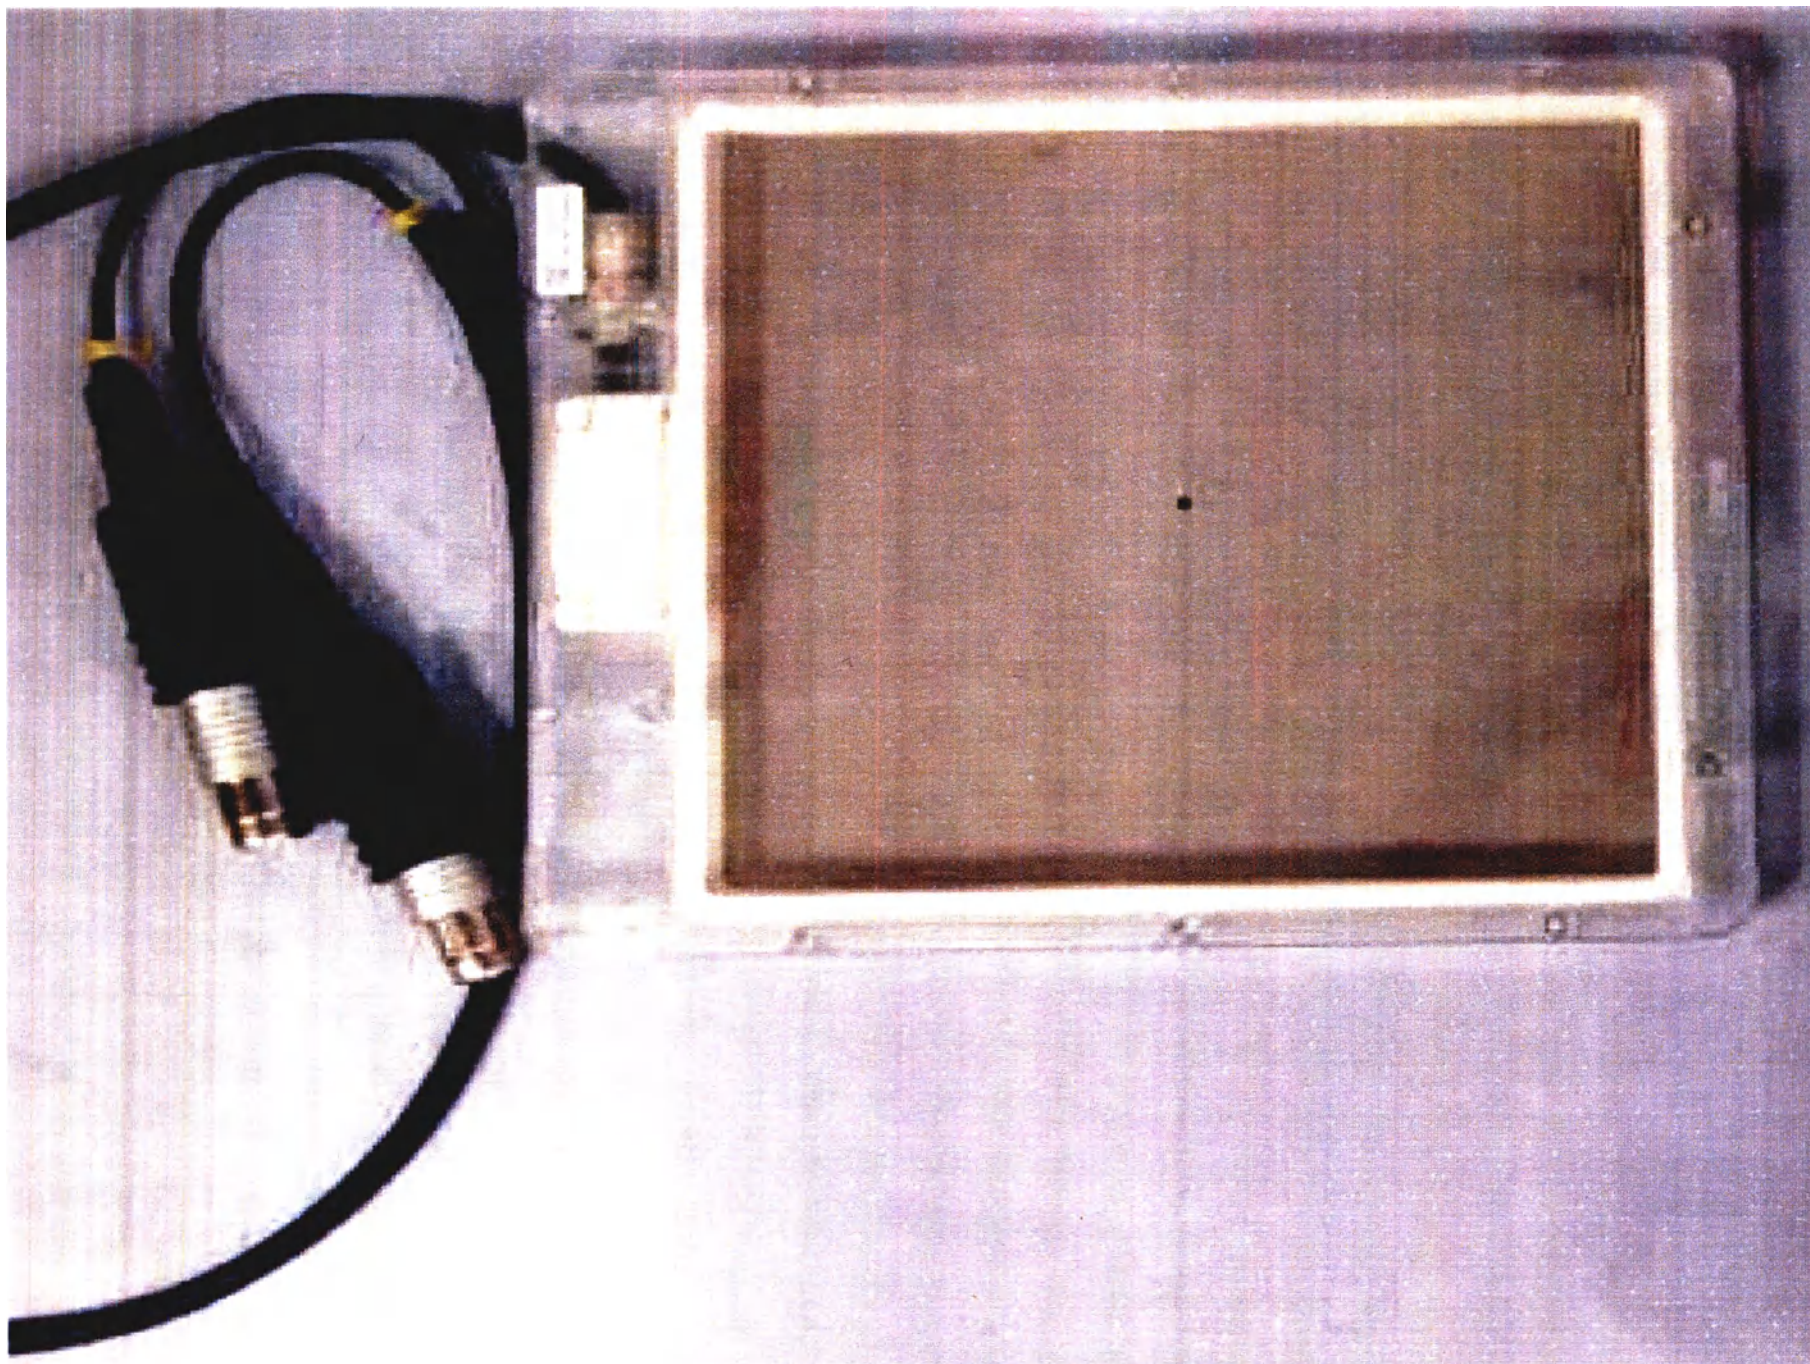


Рисунок 28. Дозиметрическое устройство DIAMENTOR M4 KDK. Ионизационная камера.



Рисунок 29. Дозиметрическое устройство DIAMENTOR RS-KDK. Устройство отображения.



Рисунок 30. Дозиметрическое устройство DIAMENTOR RS-KDK. Ионизационная камера.

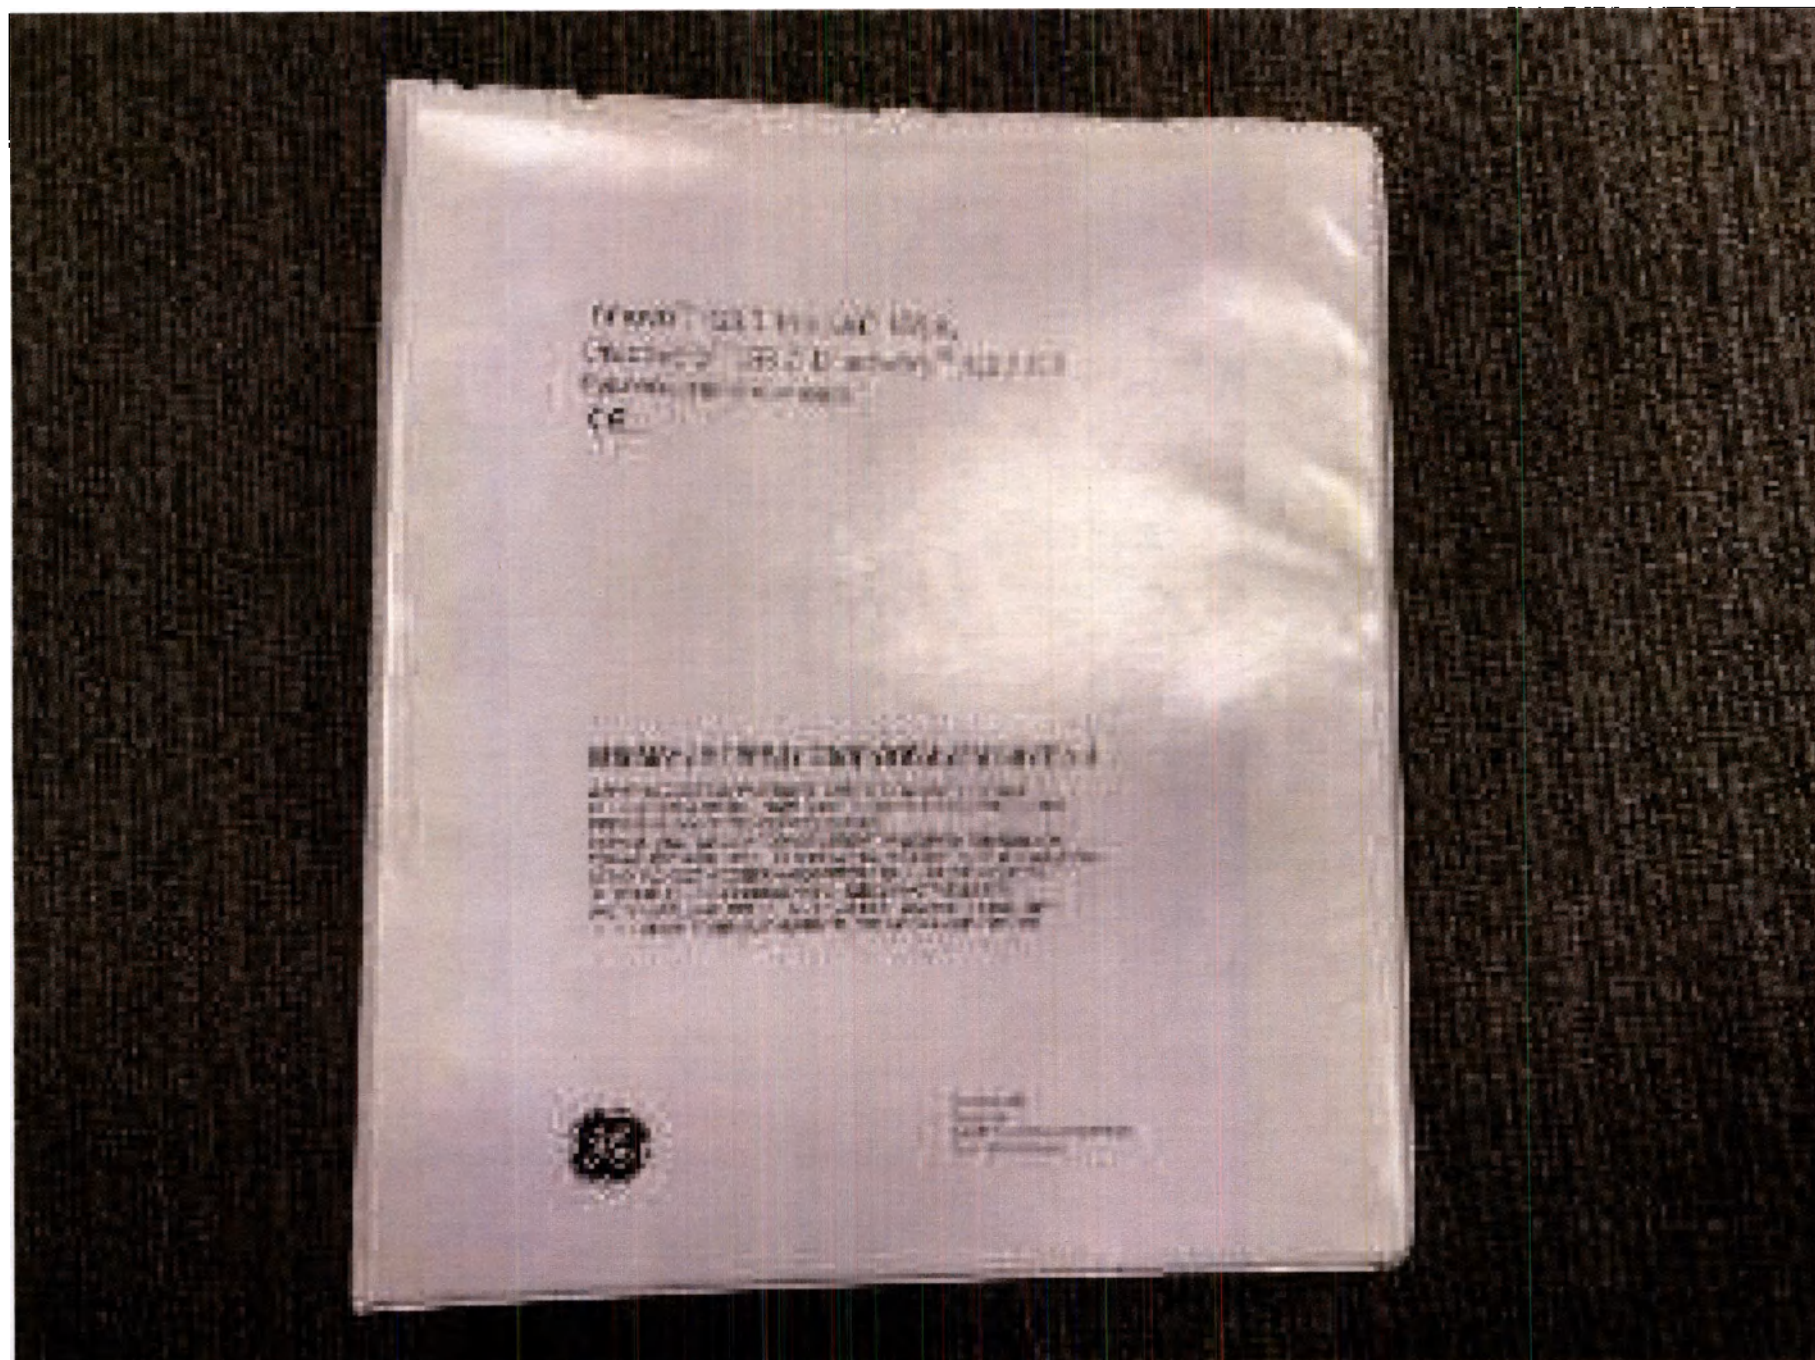


Рисунок 31. Документация пользователя.


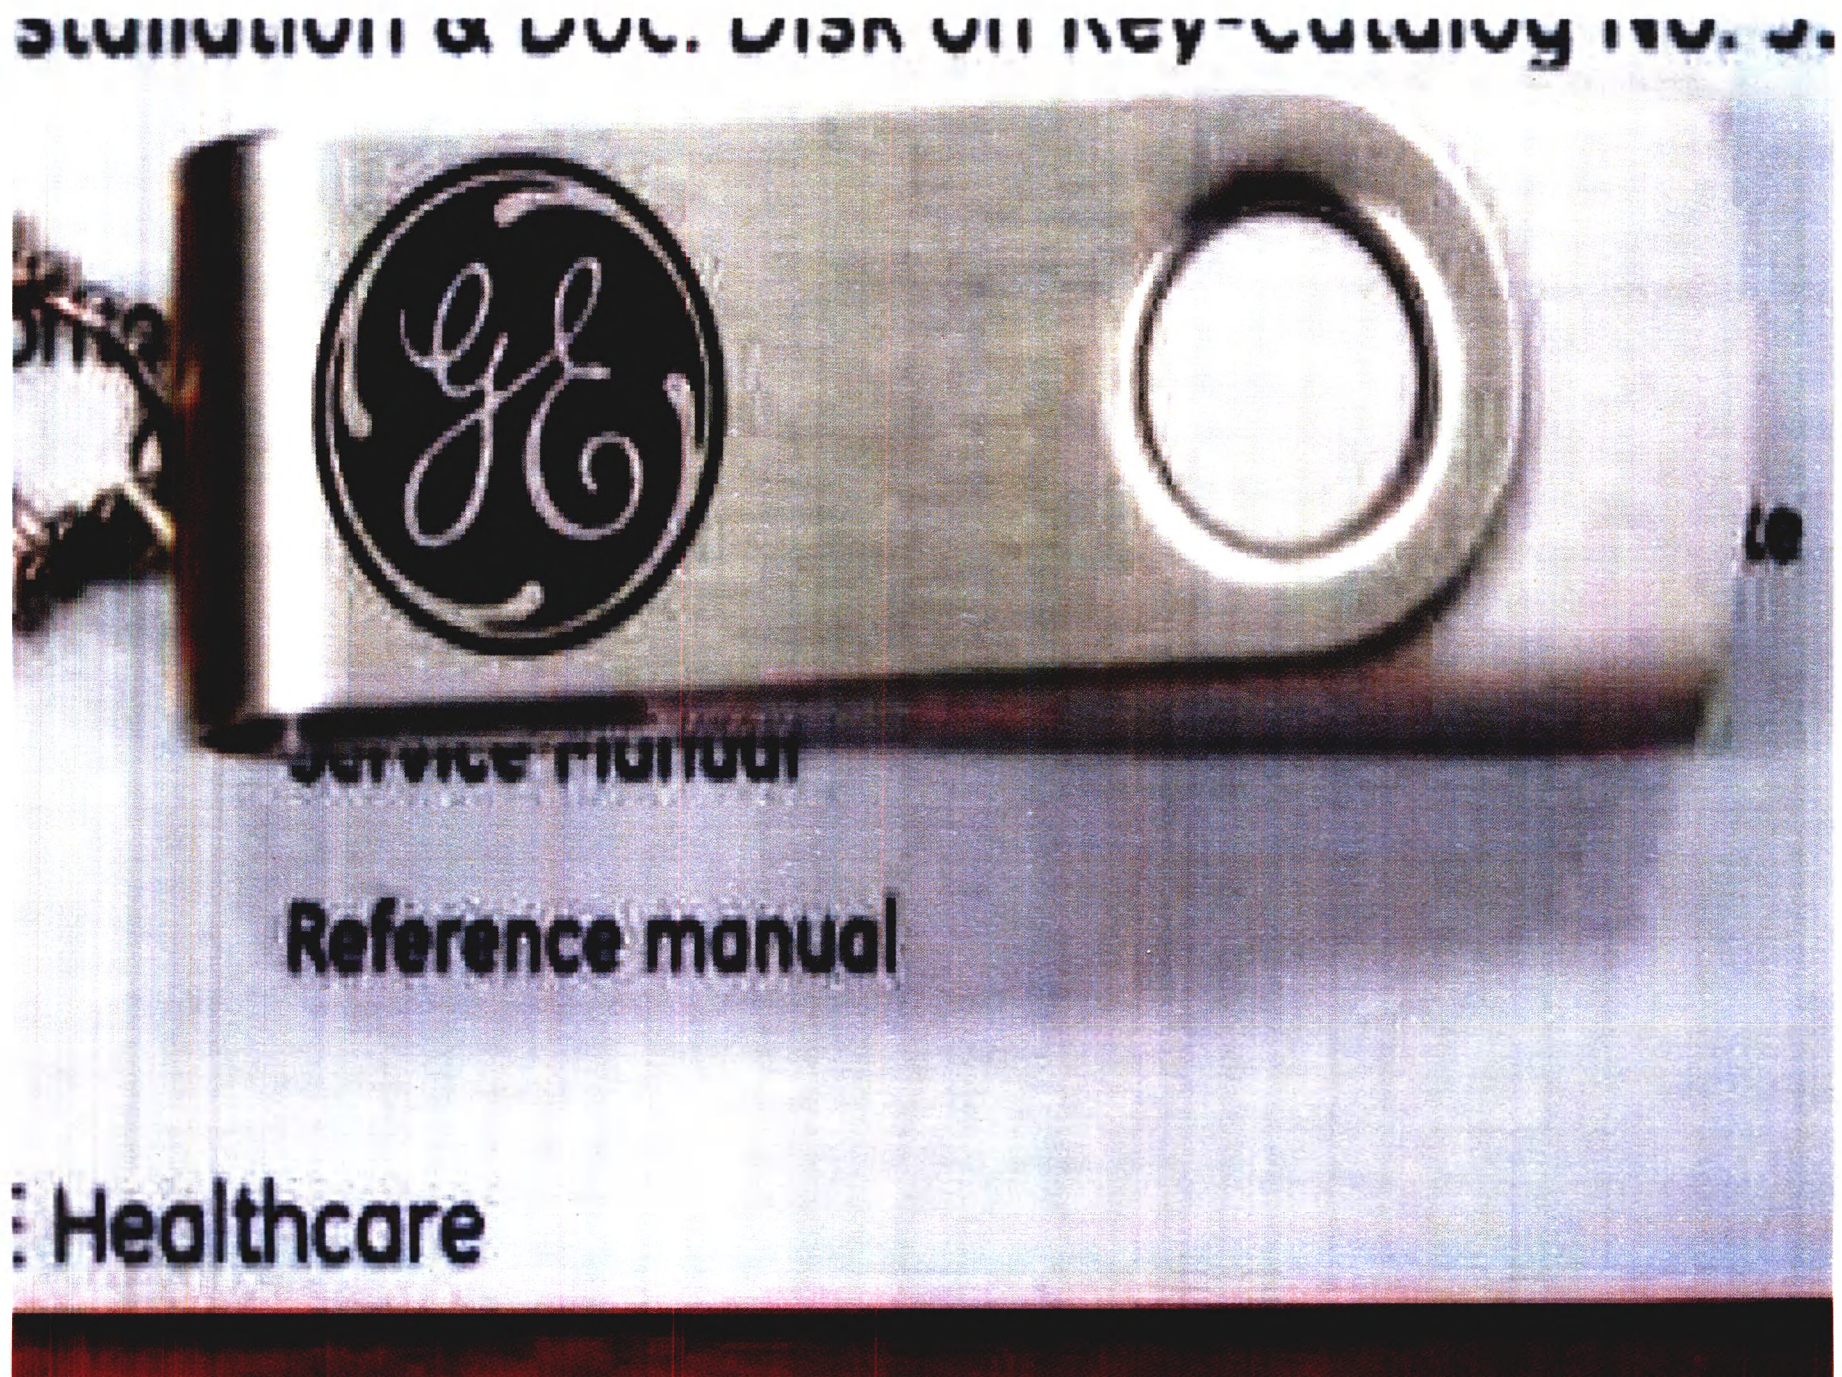


Рисунок 32. Документация техническая.

GEHC proprietary



Рисунок 33. Устройства панорамирования стола.

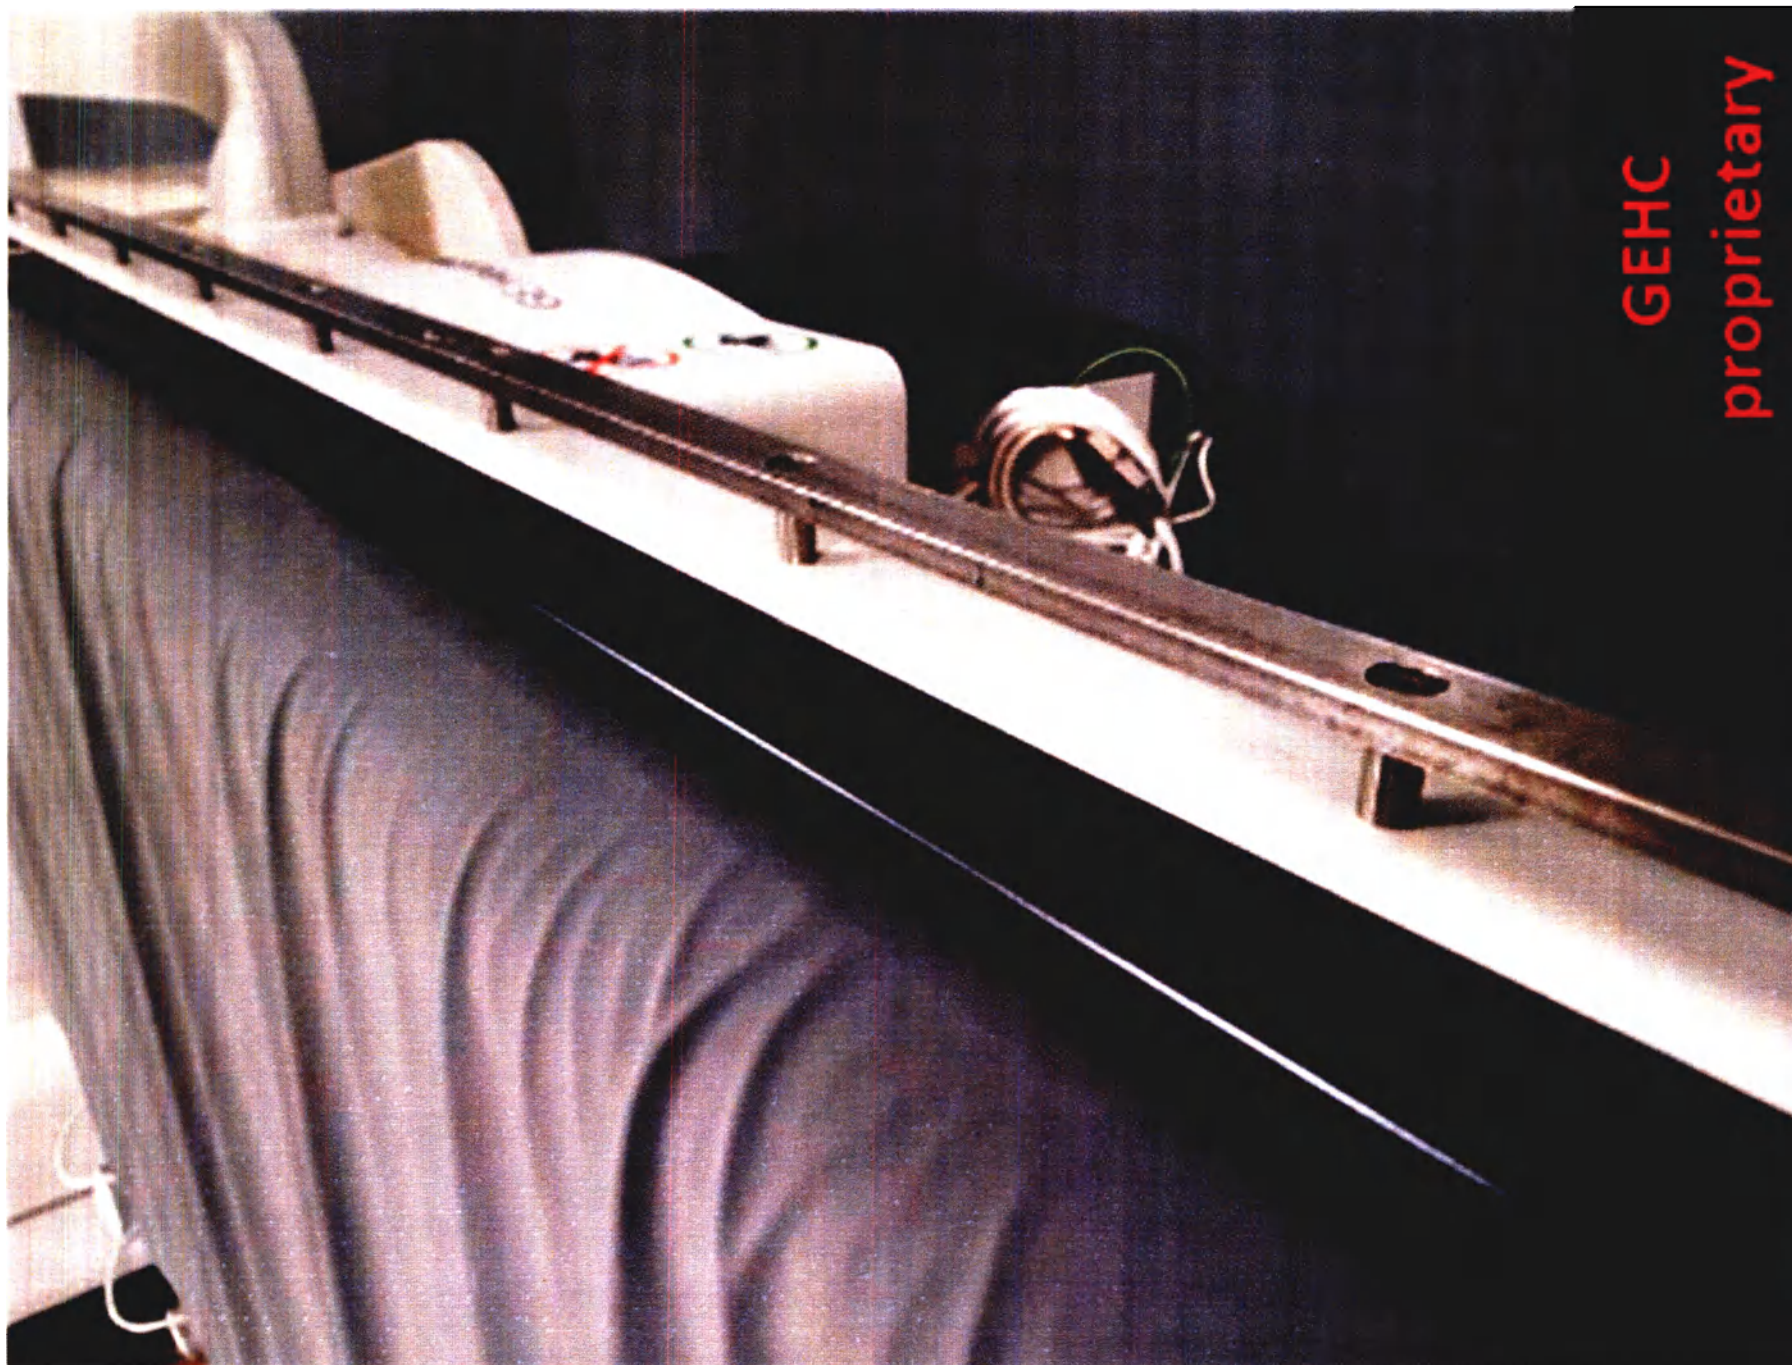

GEHC
proprietary

Рисунок 34. Рельсовый расширитель для ножного конца стола.



Рисунок 35. Устройства обслуживания стола ангиографического. Кабели.



Рисунок 36. Устройства обслуживания стола ангиографического. Кейс для инструментов.

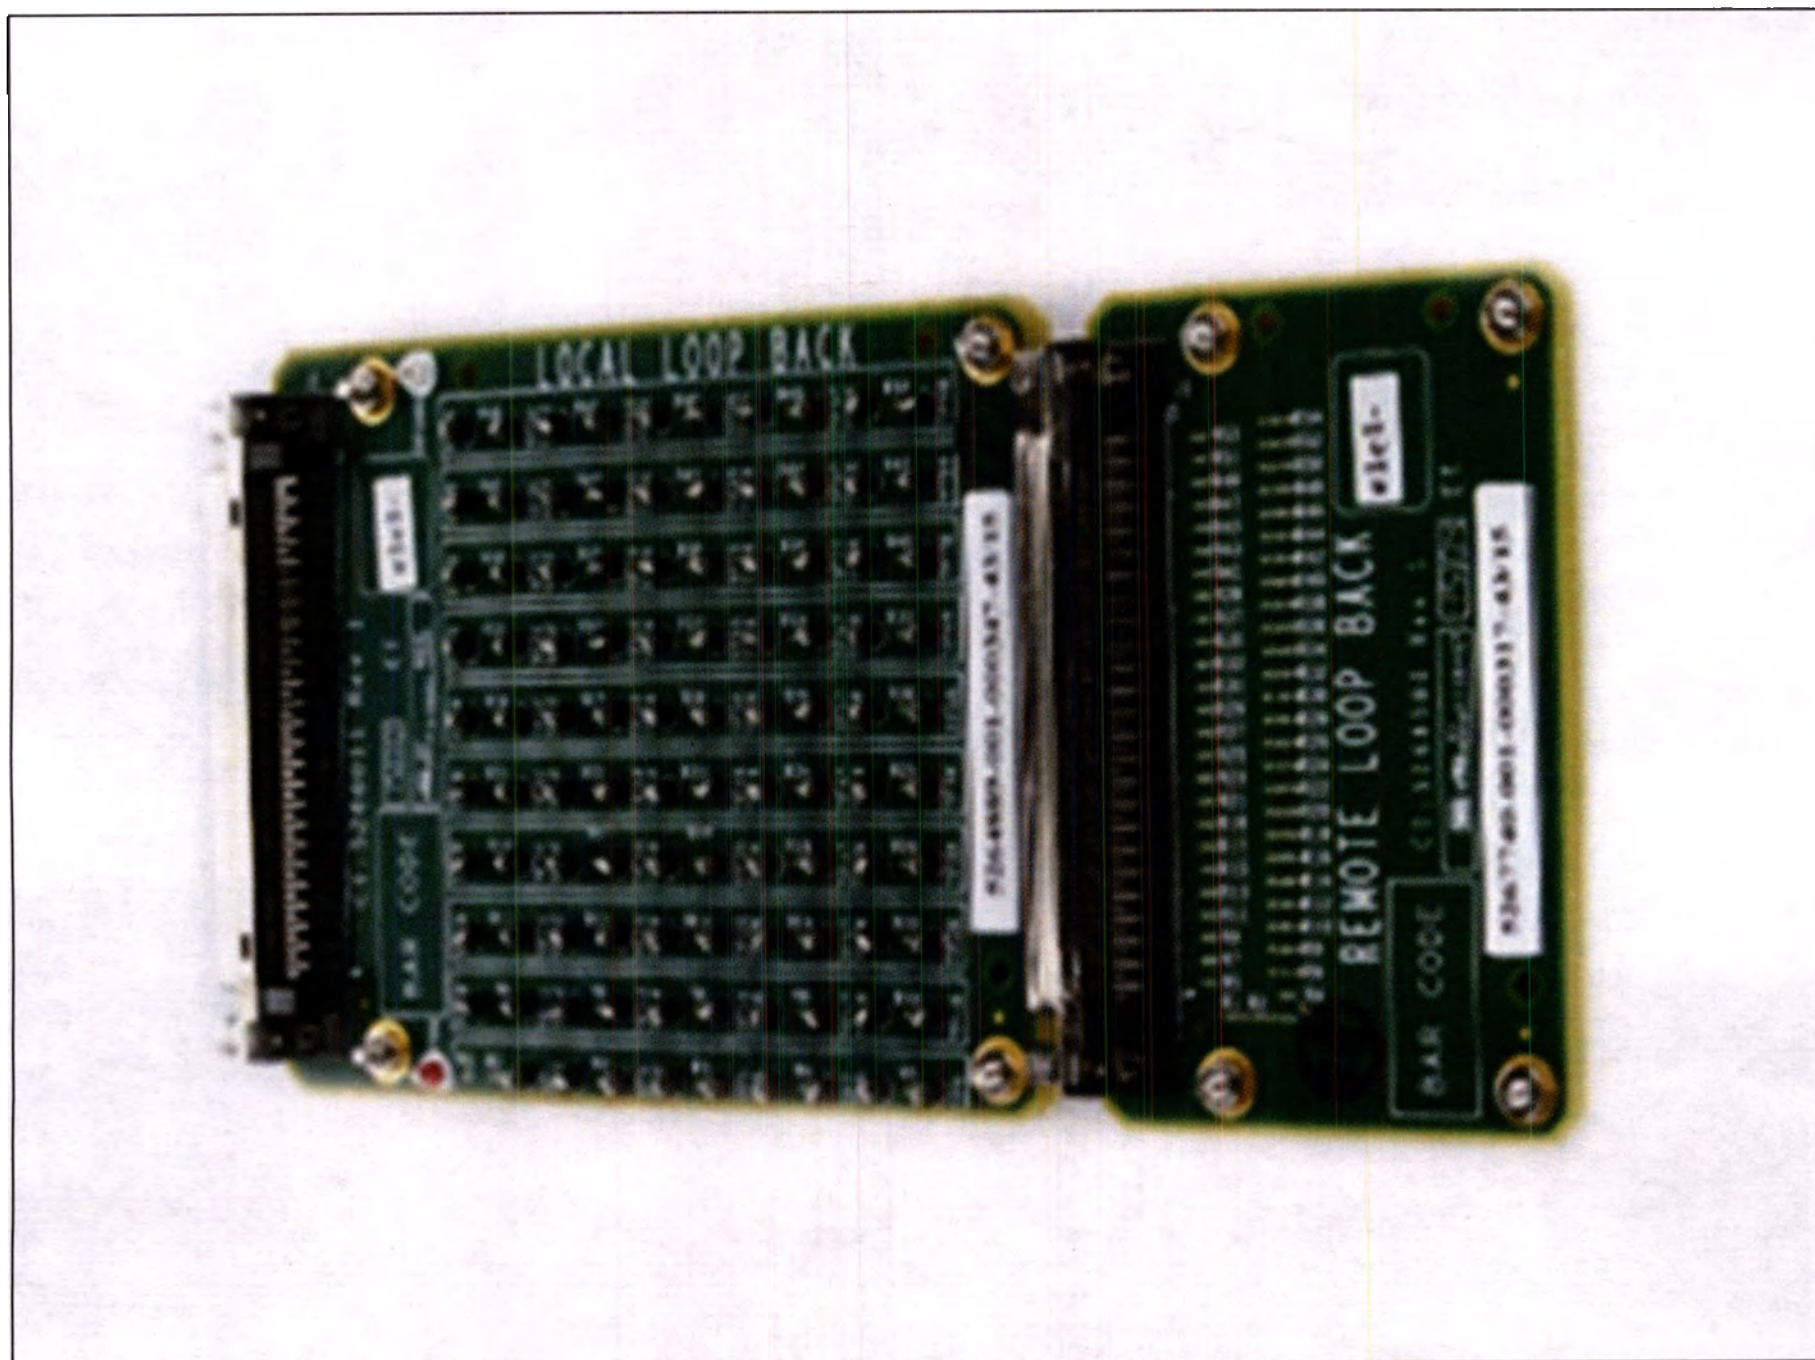



Рисунок 37. Устройства обслуживания стола ангиографического. Тестовая плата.



Рисунок 38. Устройства обслуживания стола ангиографического. Разъем с кабелями.



Рисунок 39. Устройства обслуживания стола ангиографического. Жидкость-фиксатор резьбовых соединений.

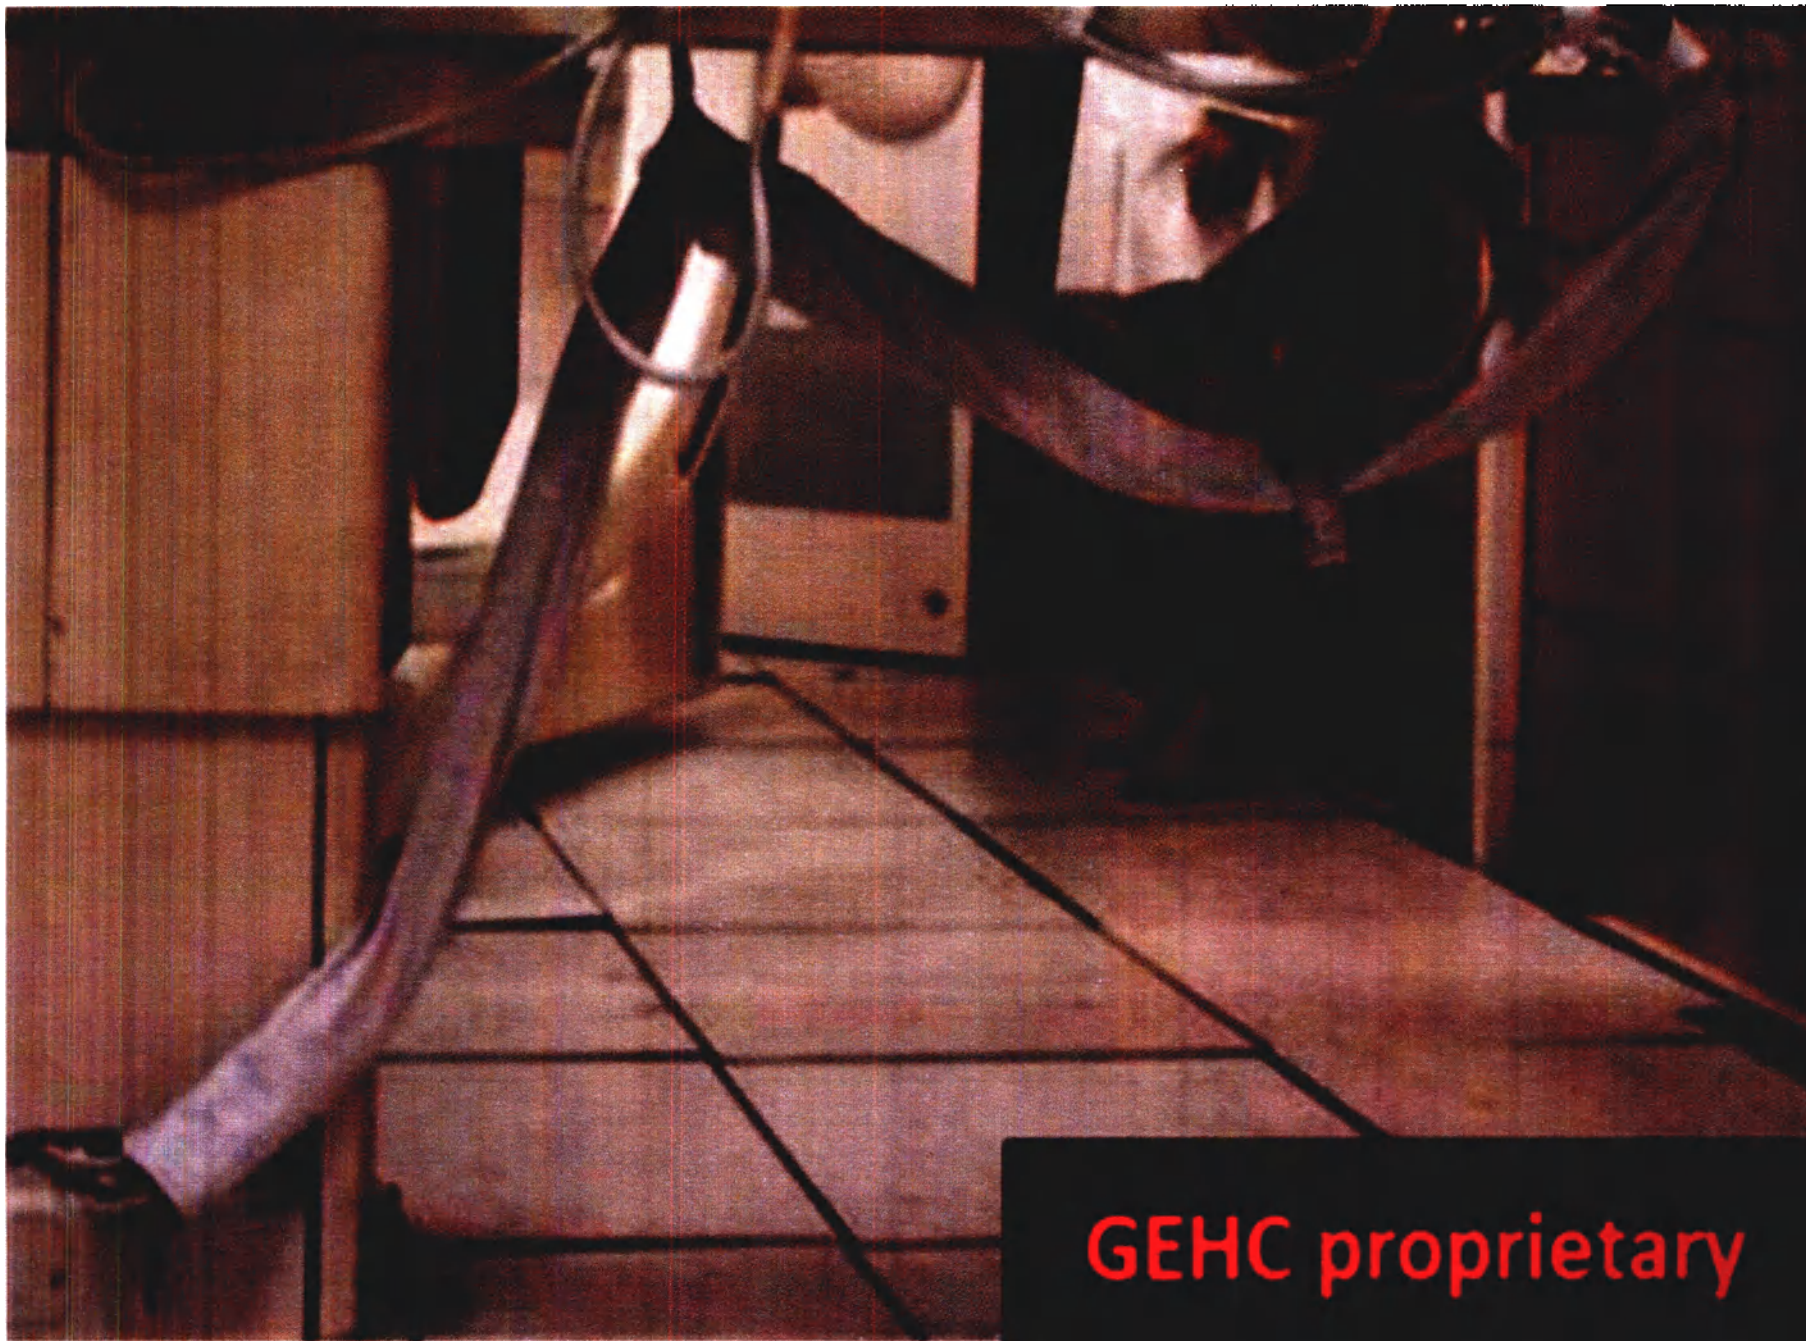

GENC proprietary

Рисунок 40. Защита кабелей ангиографического стола.

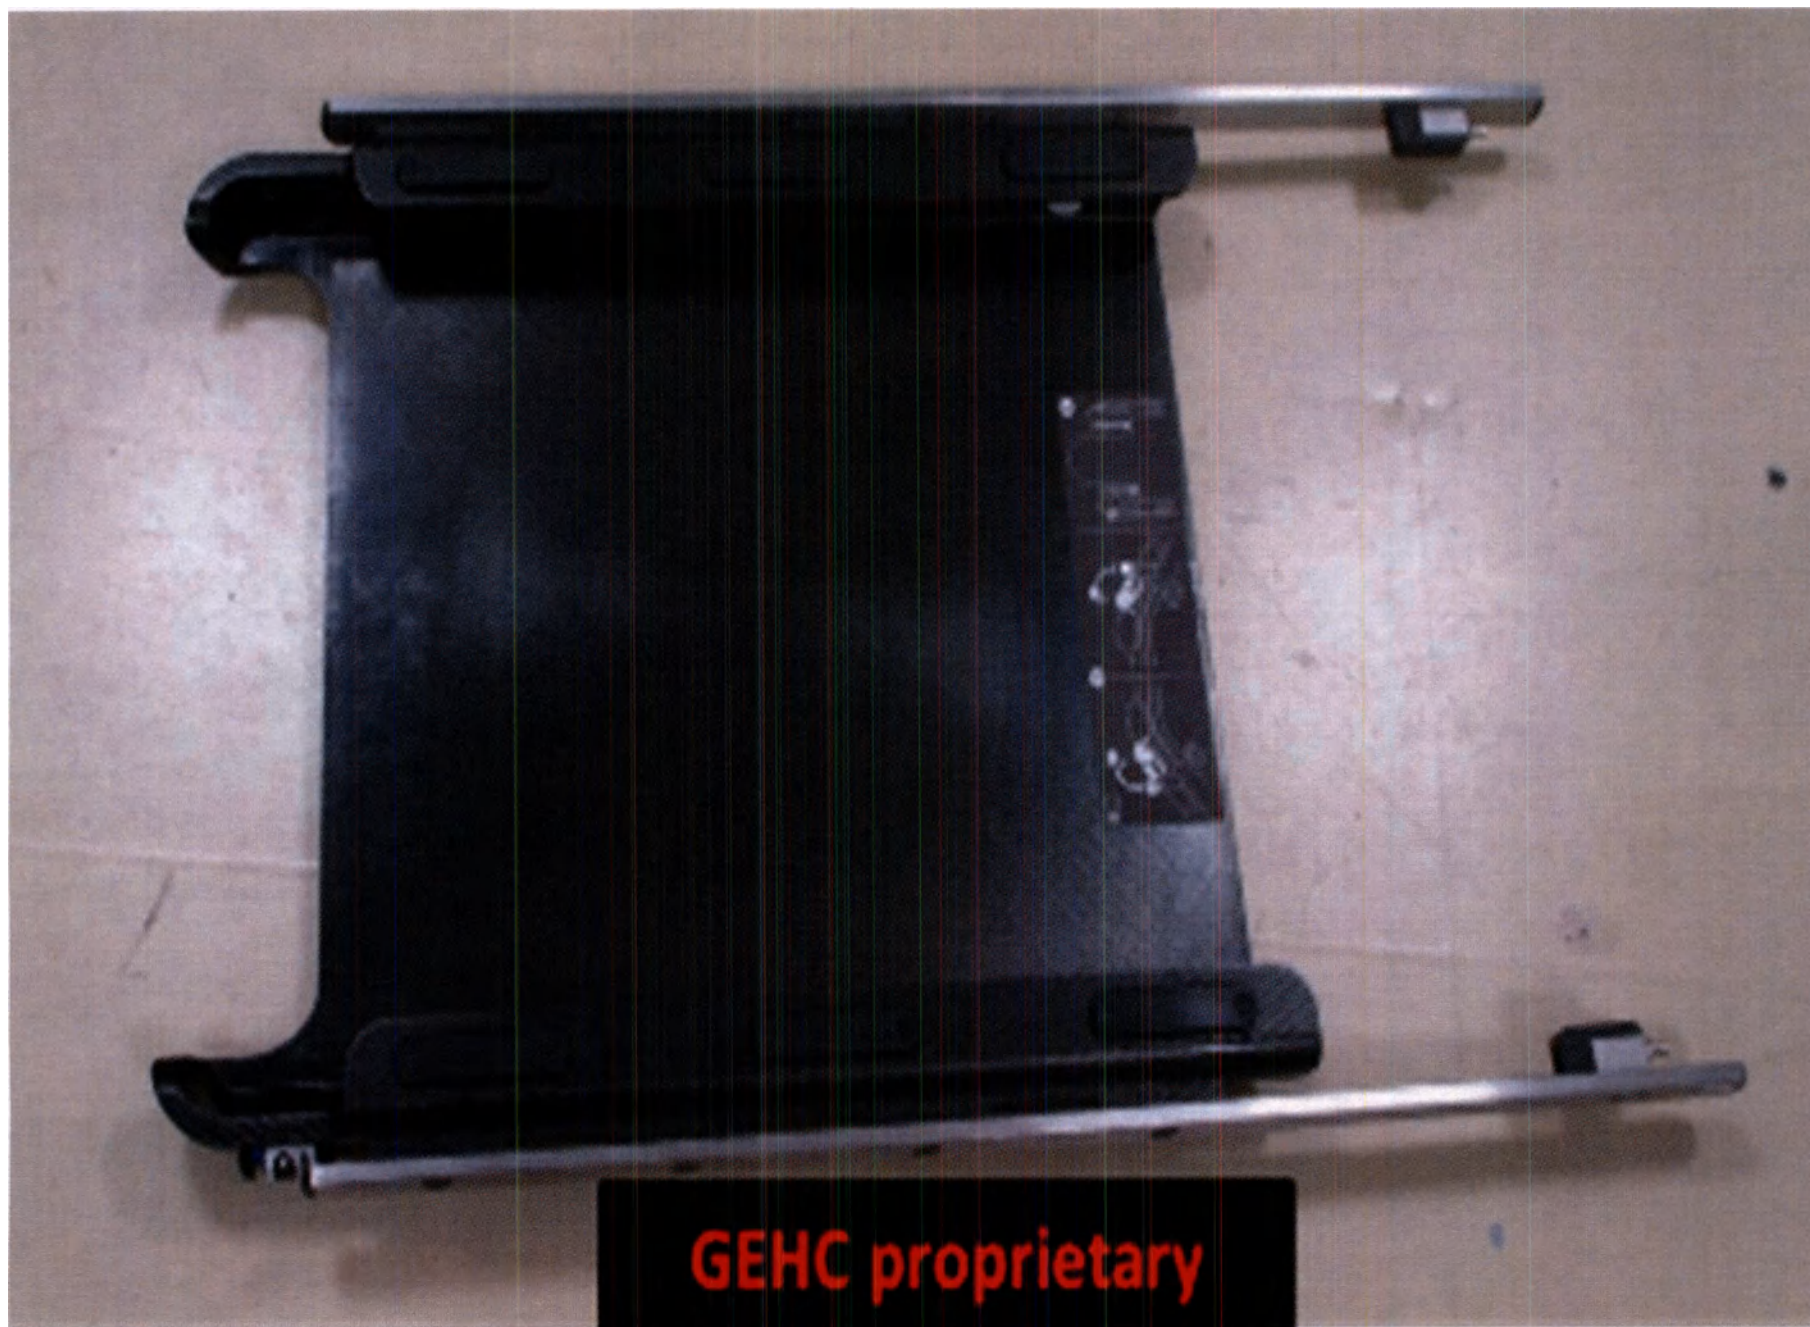


Рисунок 41. Рельсы для подвешного оборудования.

ГЕНС proprietary

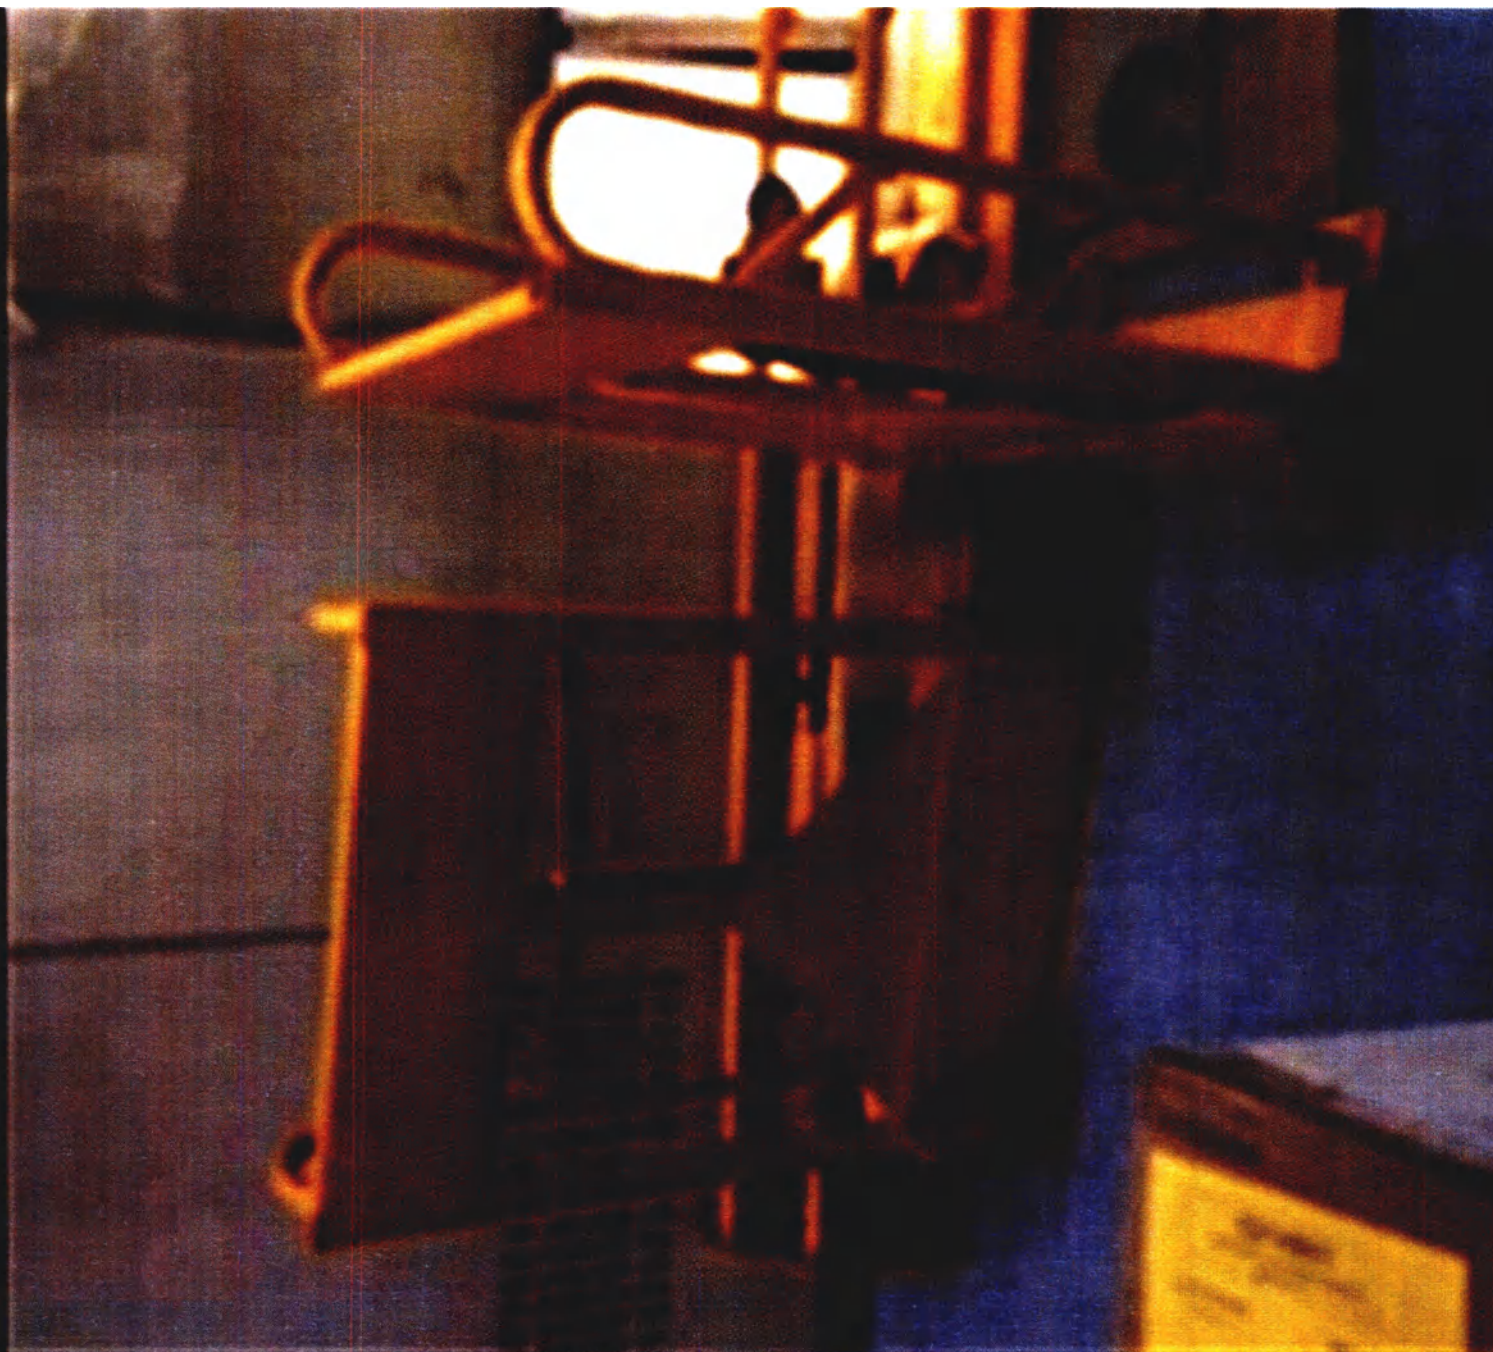


Рисунок 42. Устройства для подготовки к установке системы. Тележки для разгрузки и монтажа системы.

GEHC proprietary



Рисунок 43. Кабели для монтажа системы.

GEHC proprietary



Рисунок 44. Кабель для видео соединения ангиографической системы с системой гемодинамического мониторинга.

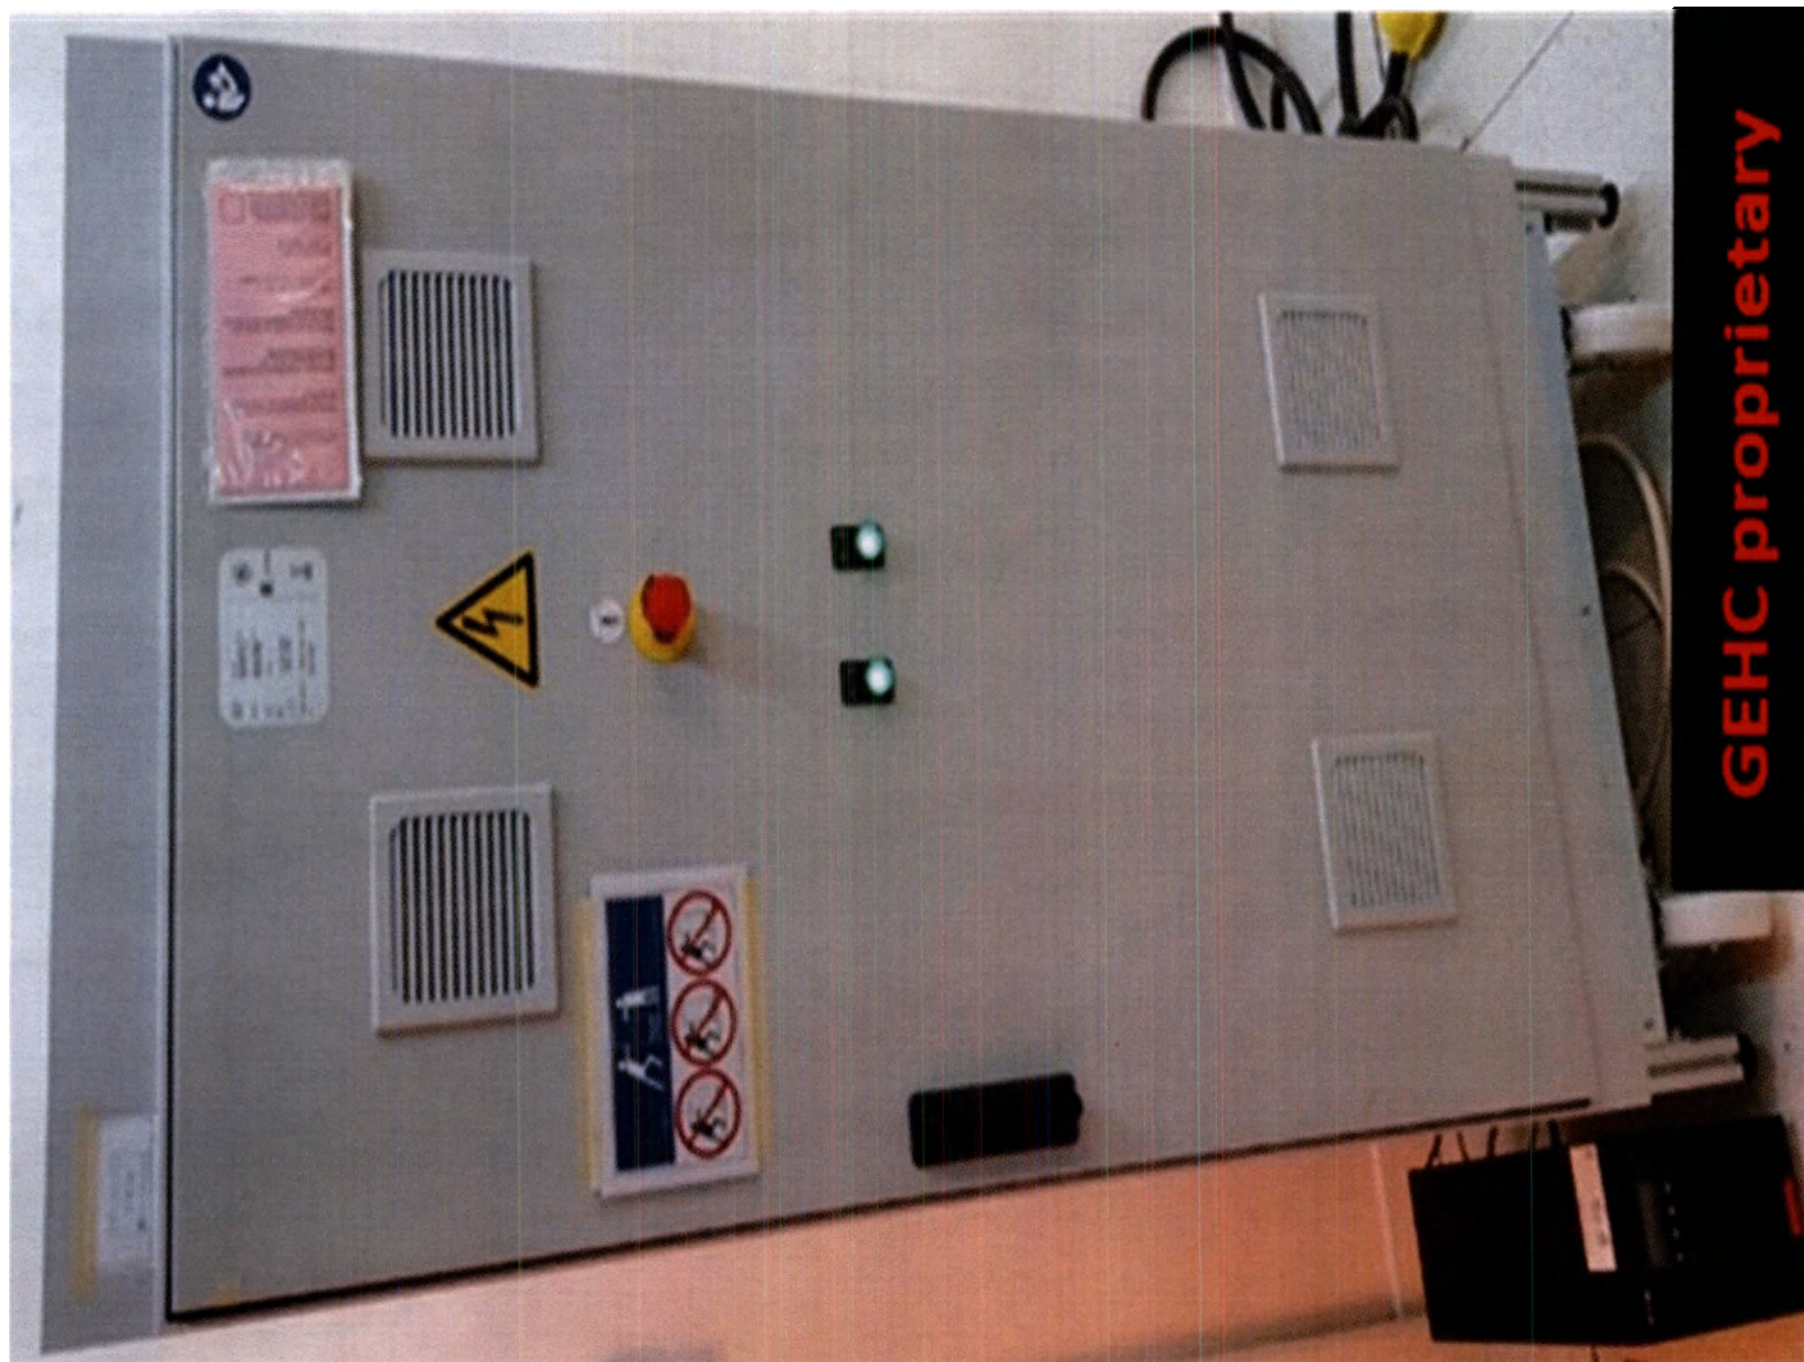


Рисунок 45. Силовой распределительный щит.

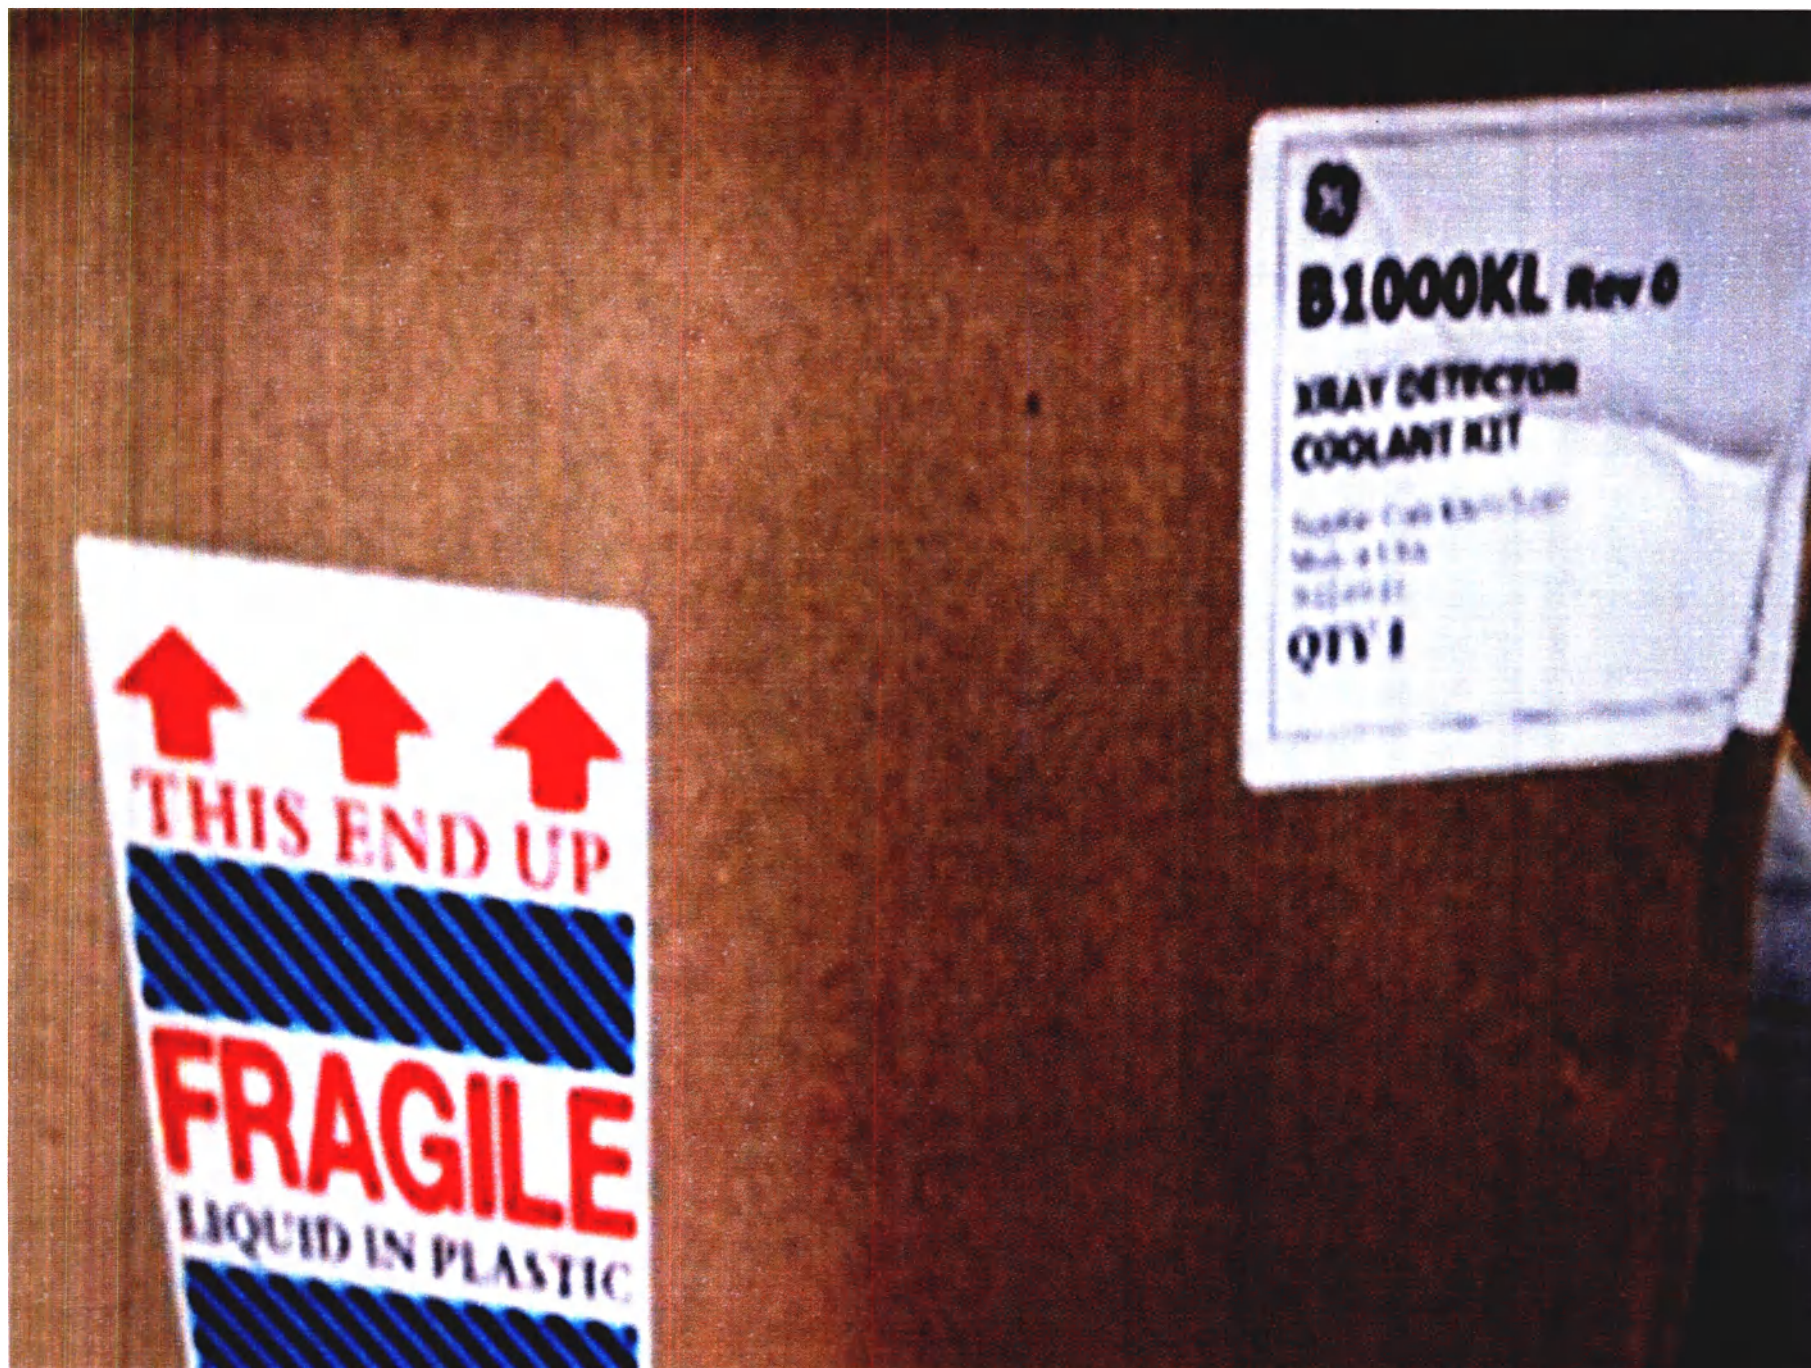


Рисунок 46. Система охлаждения цифрового детектора.



Рисунок 47. Система охлаждения цифрового детектора.



Рисунок 48. Система охлаждения цифрового детектора.

GEHC proprietary



Рисунок 49. Педальные переключатели (педальный переключатель для Innova IGS 6).



Рисунок 50. Педальные переключатели (педальный переключатель для Innova IGS 5).



Рисунок 51. Панели управления позиционером.



Рисунок 52. Джойстики управления позиционером.

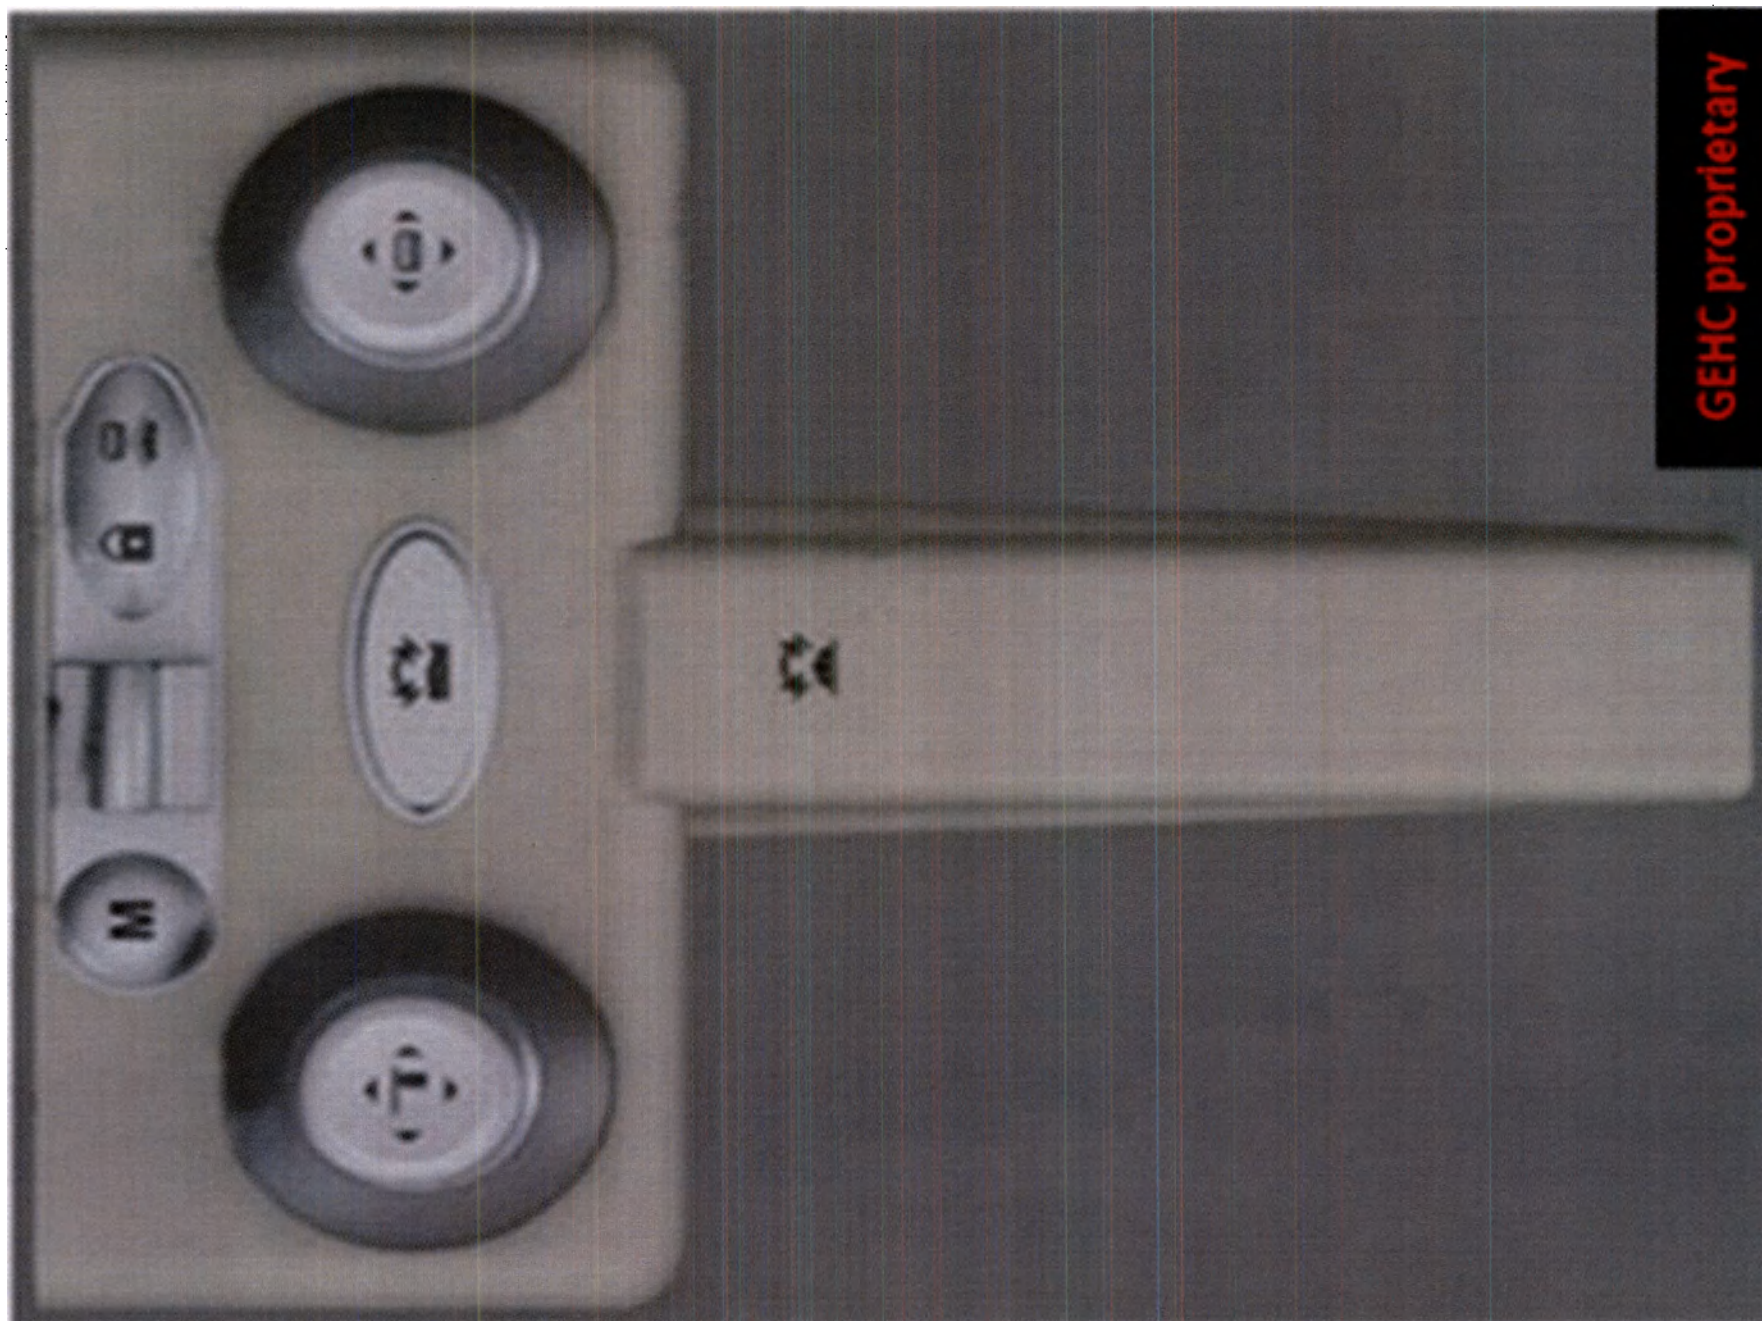


Рисунок 53. Рукоятки управления позиционером.



Рисунок 54. Рабочая станция АW для просмотра, обработки и архивации медицинских изображений.



Рисунок 55. Кабели для рабочей станции АW.



ГЕНС proprietary

Рисунок 56. Источник бесперебойного питания ангиографической системы (8 кВА).



Рисунок 57. Источник бесперебойного питания ангиографической системы (1 кВА).



Рисунок 58. Источник бесперебойного питания ангиографической системы (20 кВА).

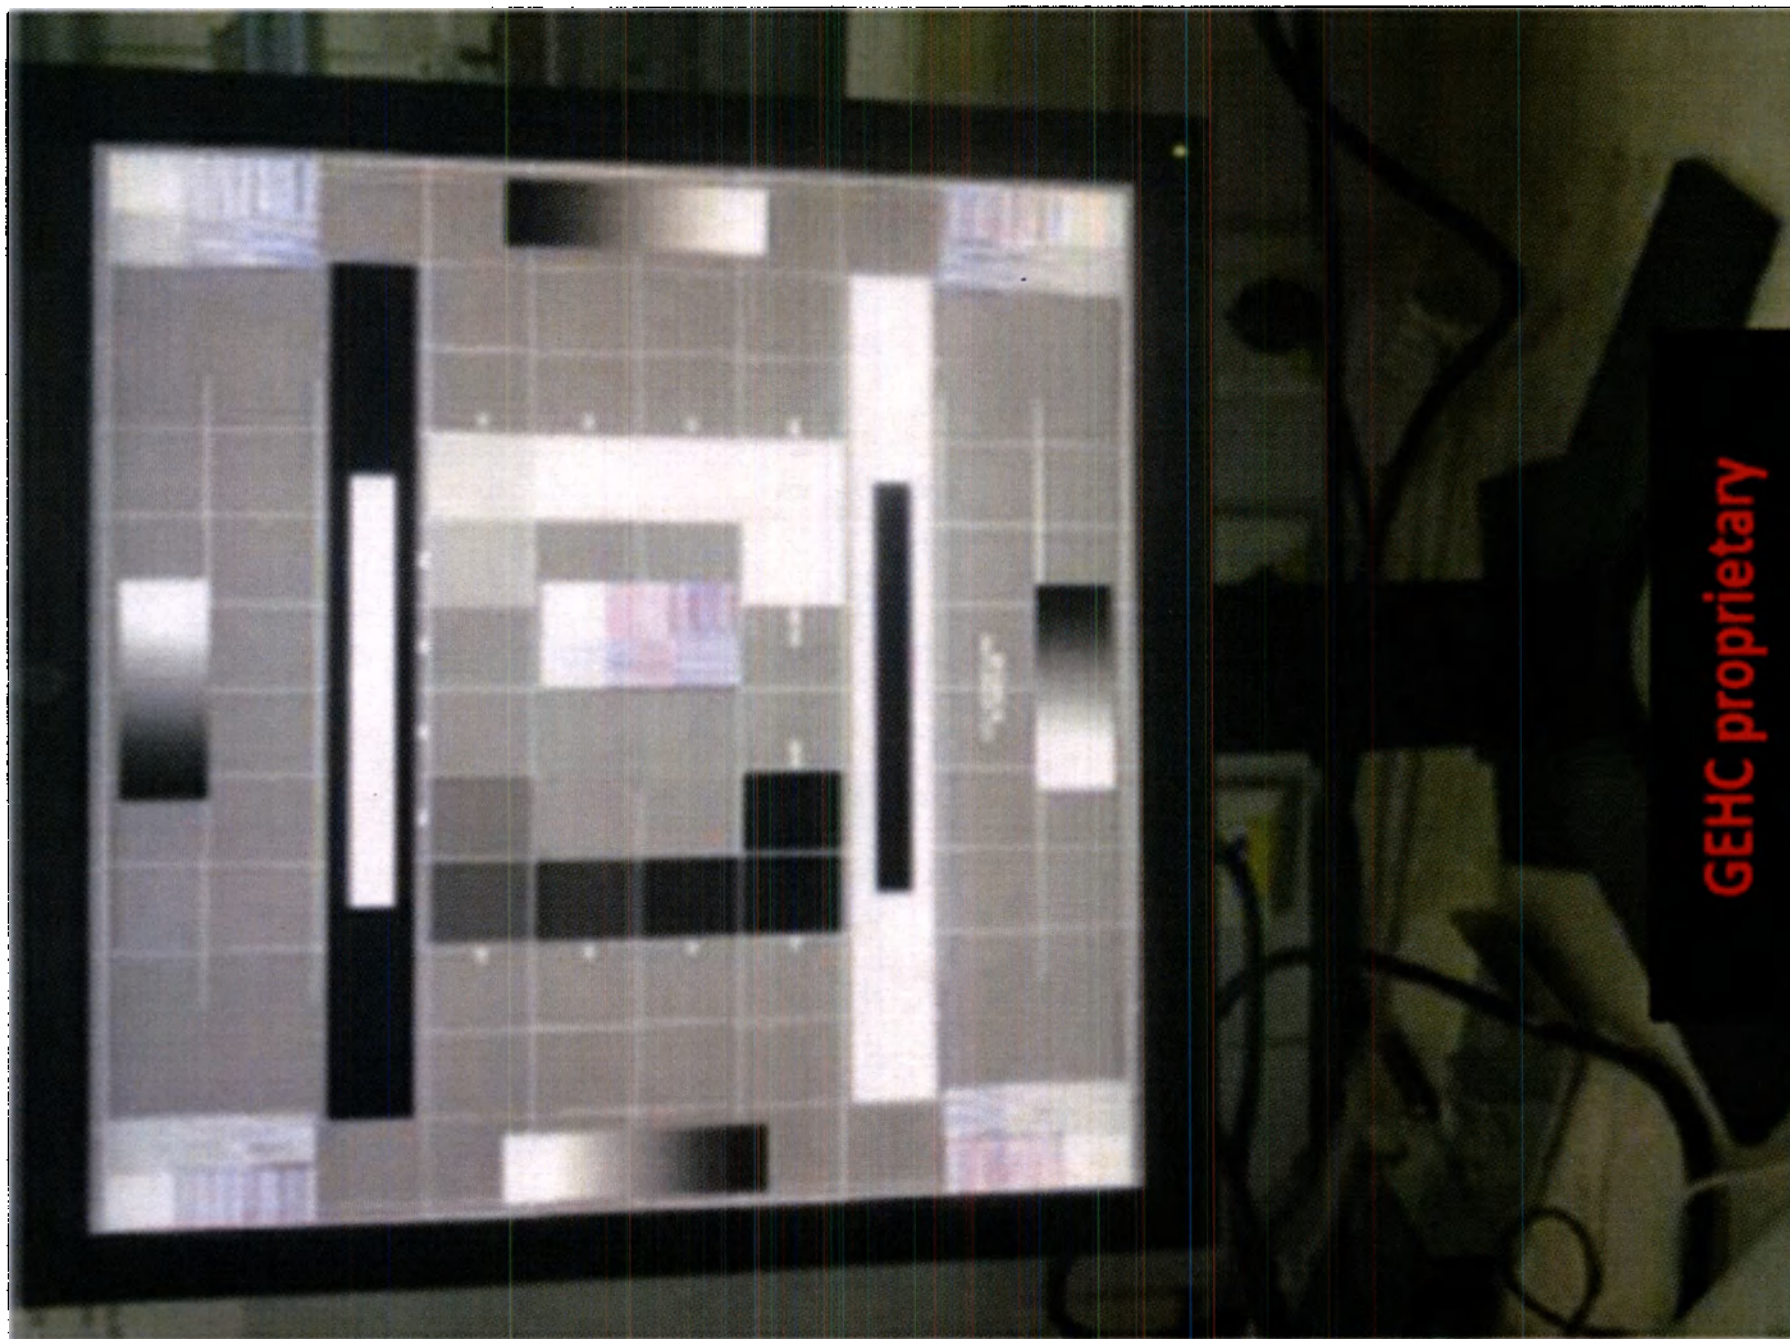


Рисунок 59. Медицинские мониторы для вывода живого и референсного изображения.

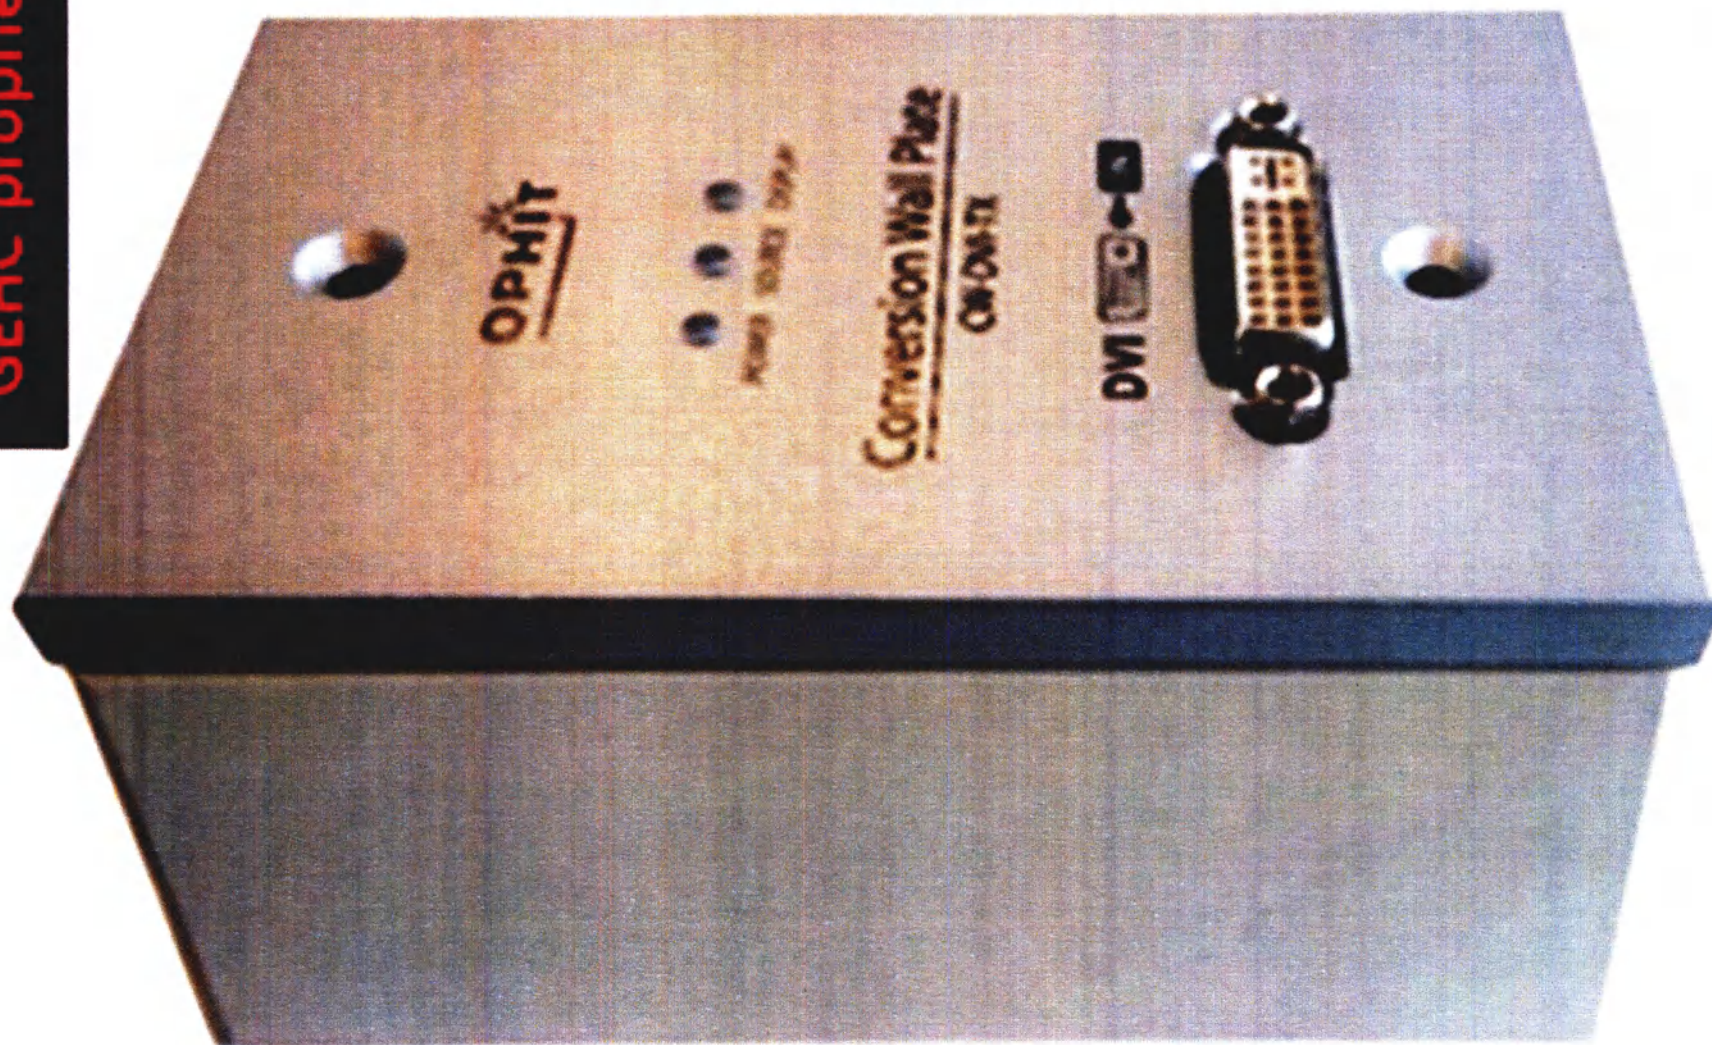


Рисунок 60. Интерфейс для подключения сторонних источников изображения к монитору в процедурной.

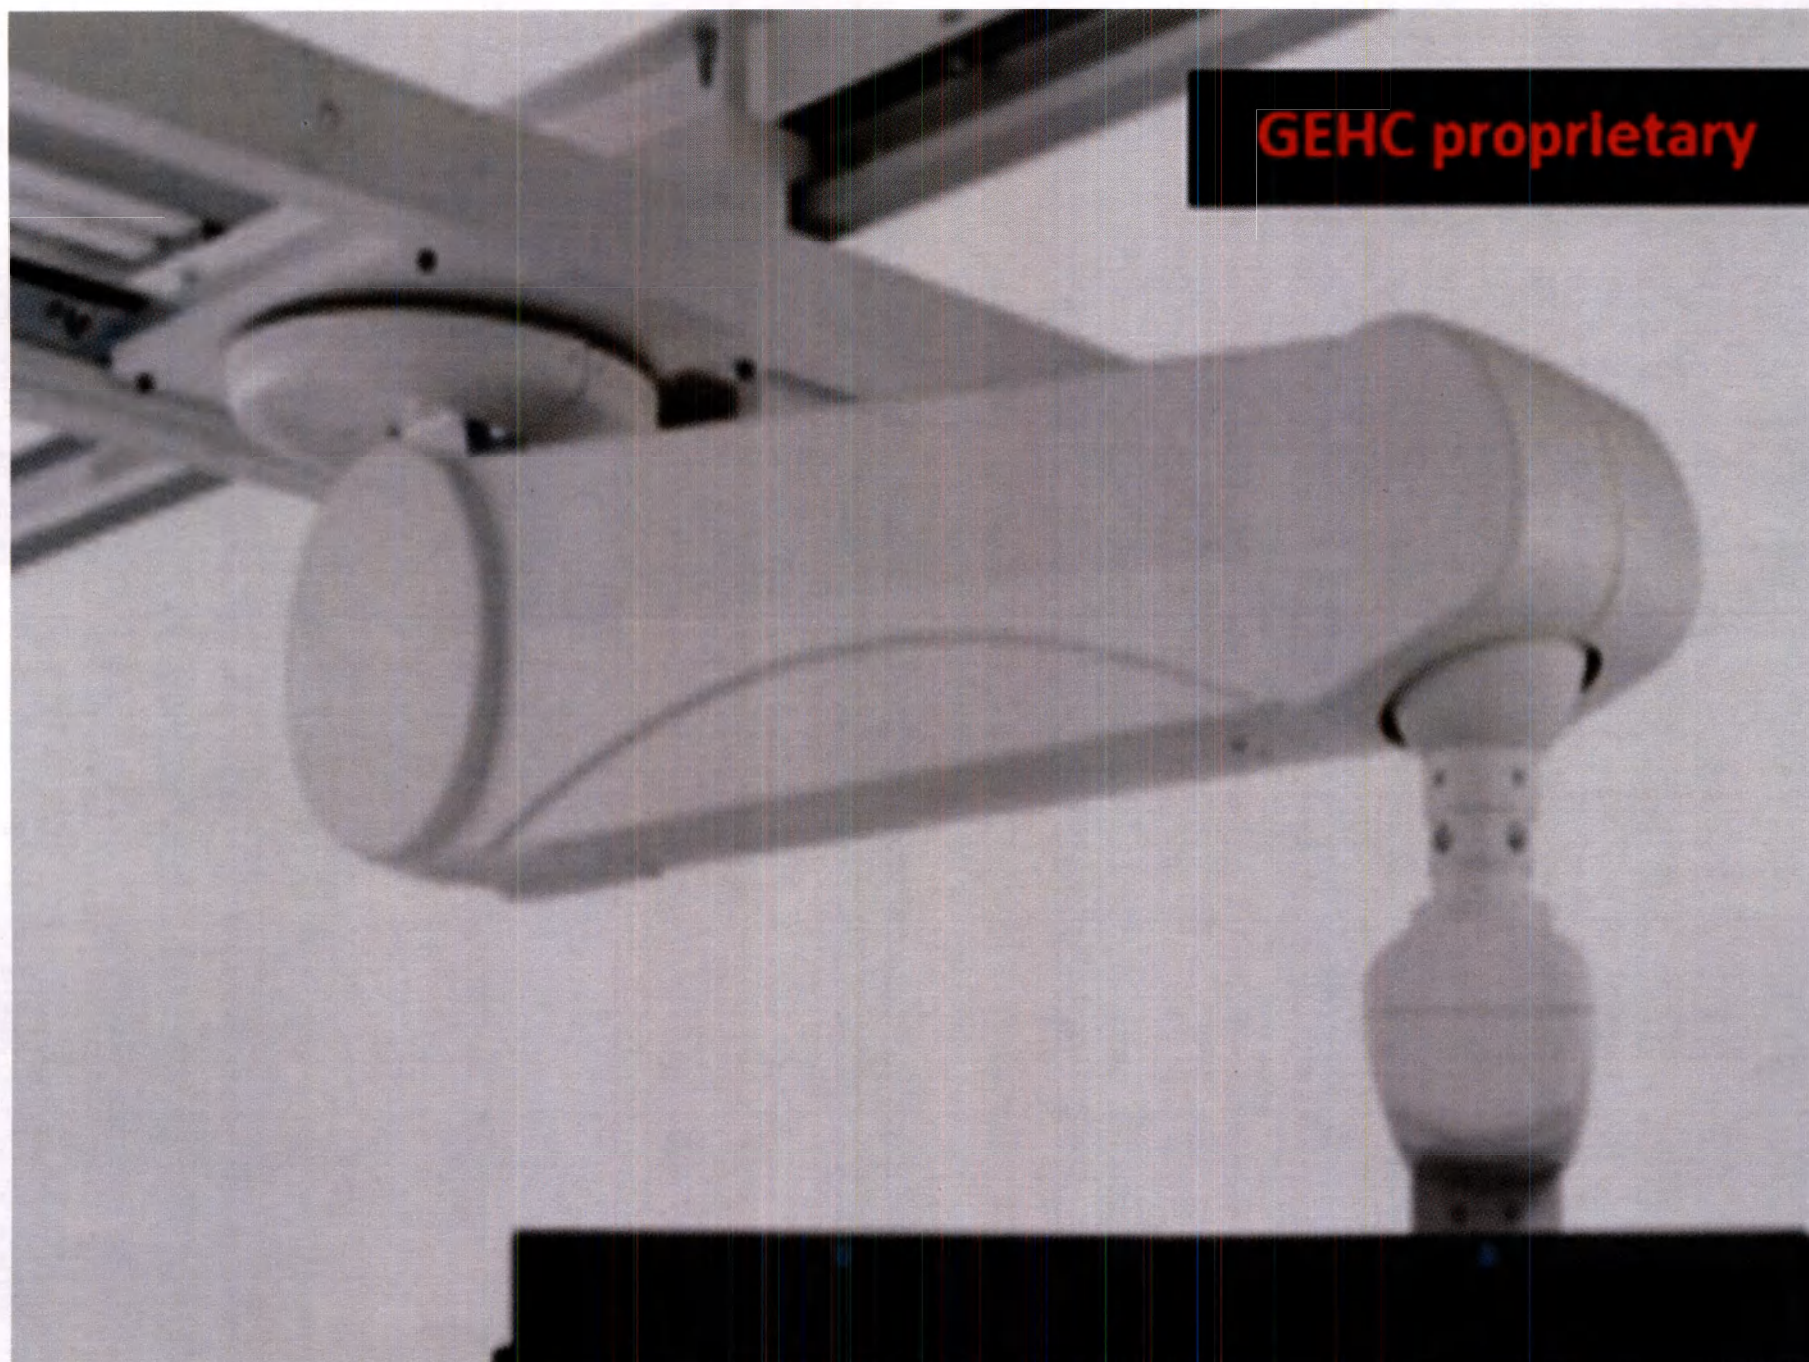


Рисунок 61. Подвески для крепления мониторов в процедурной с потолочным креплением.

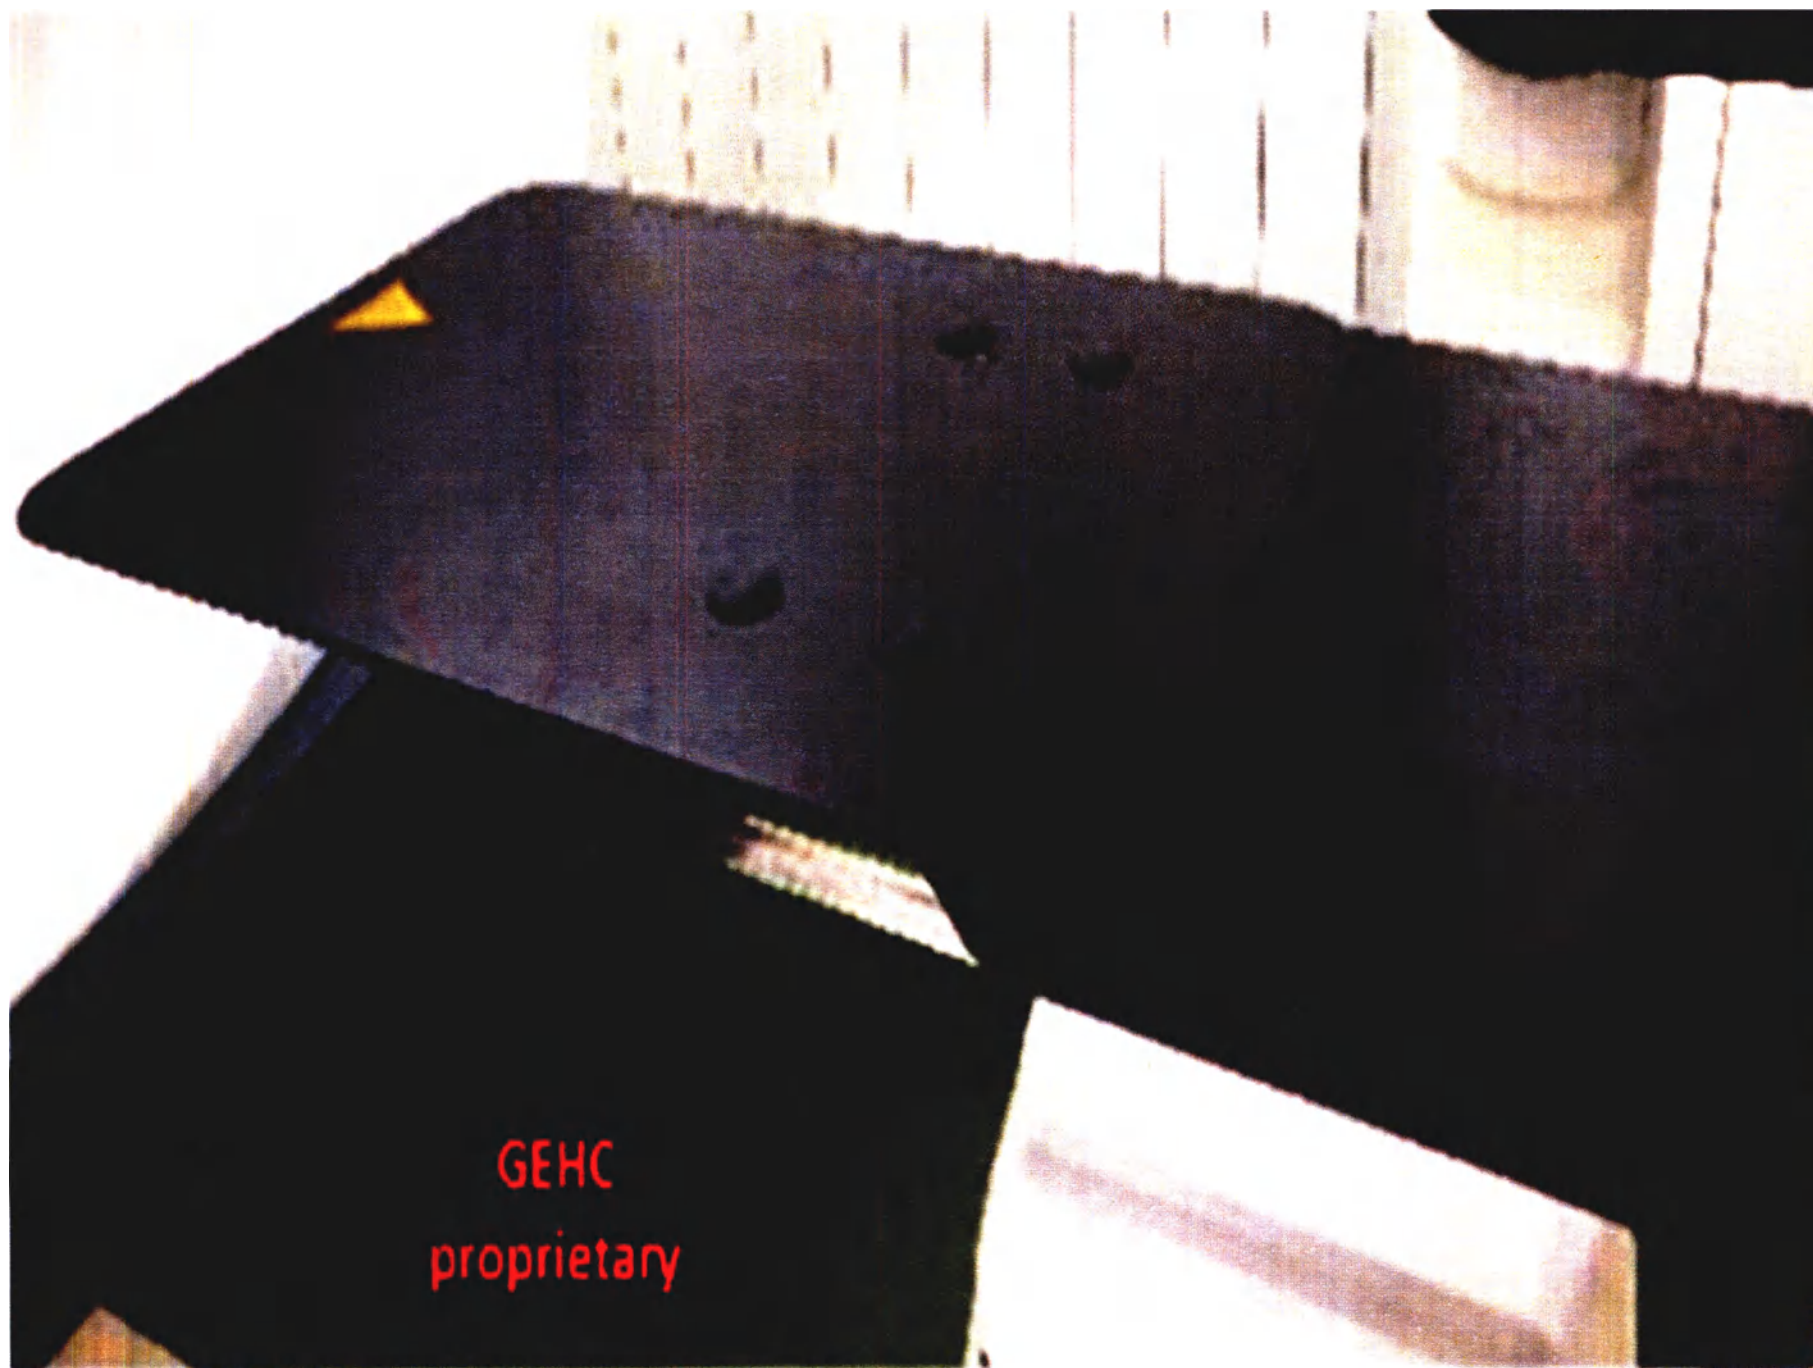


Рисунок 62. Подголовник - удлинитель для стола ангиографического.

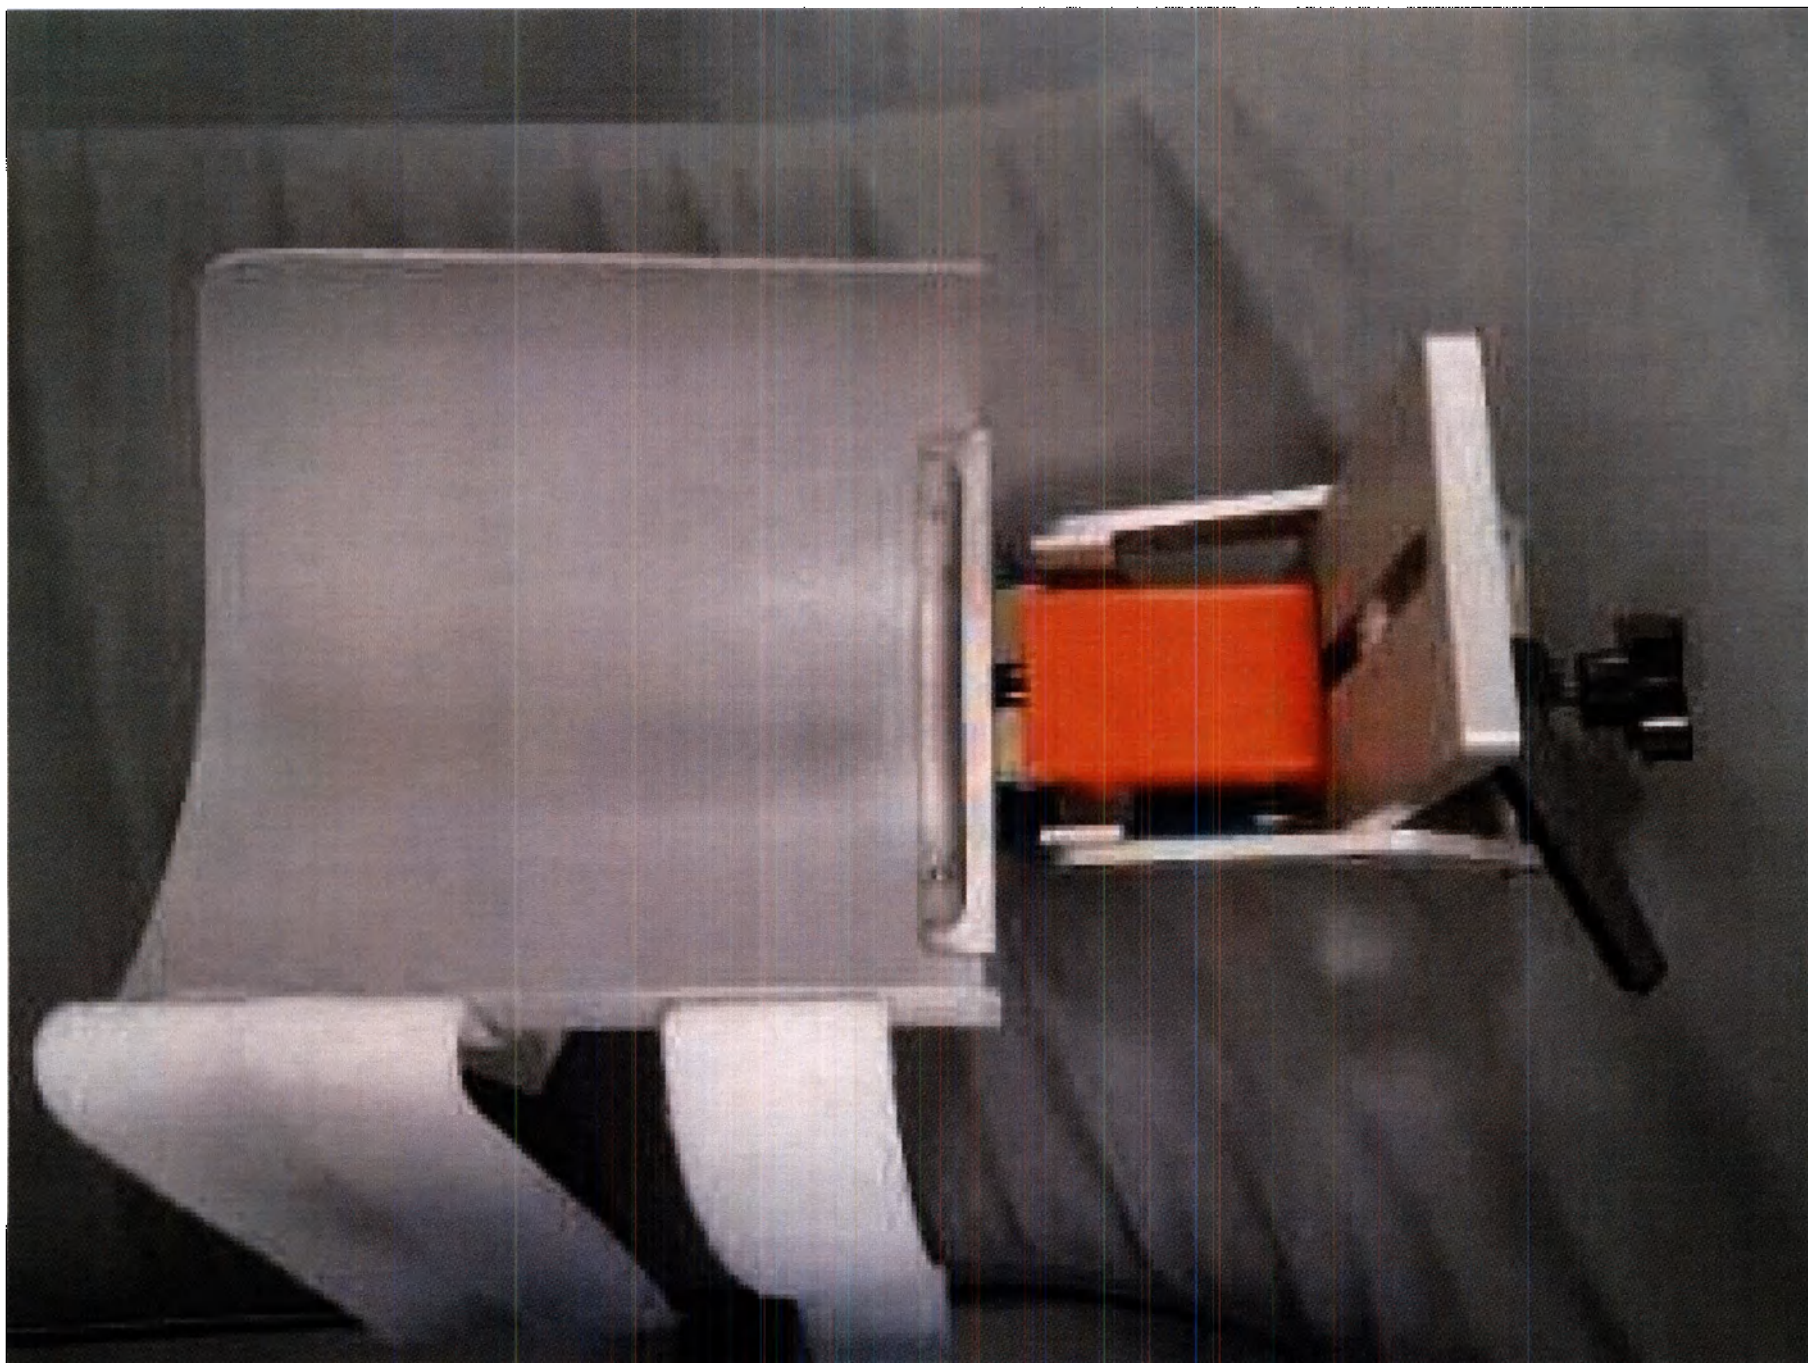


Рисунок 63. Подголовник для исследования сосудов.

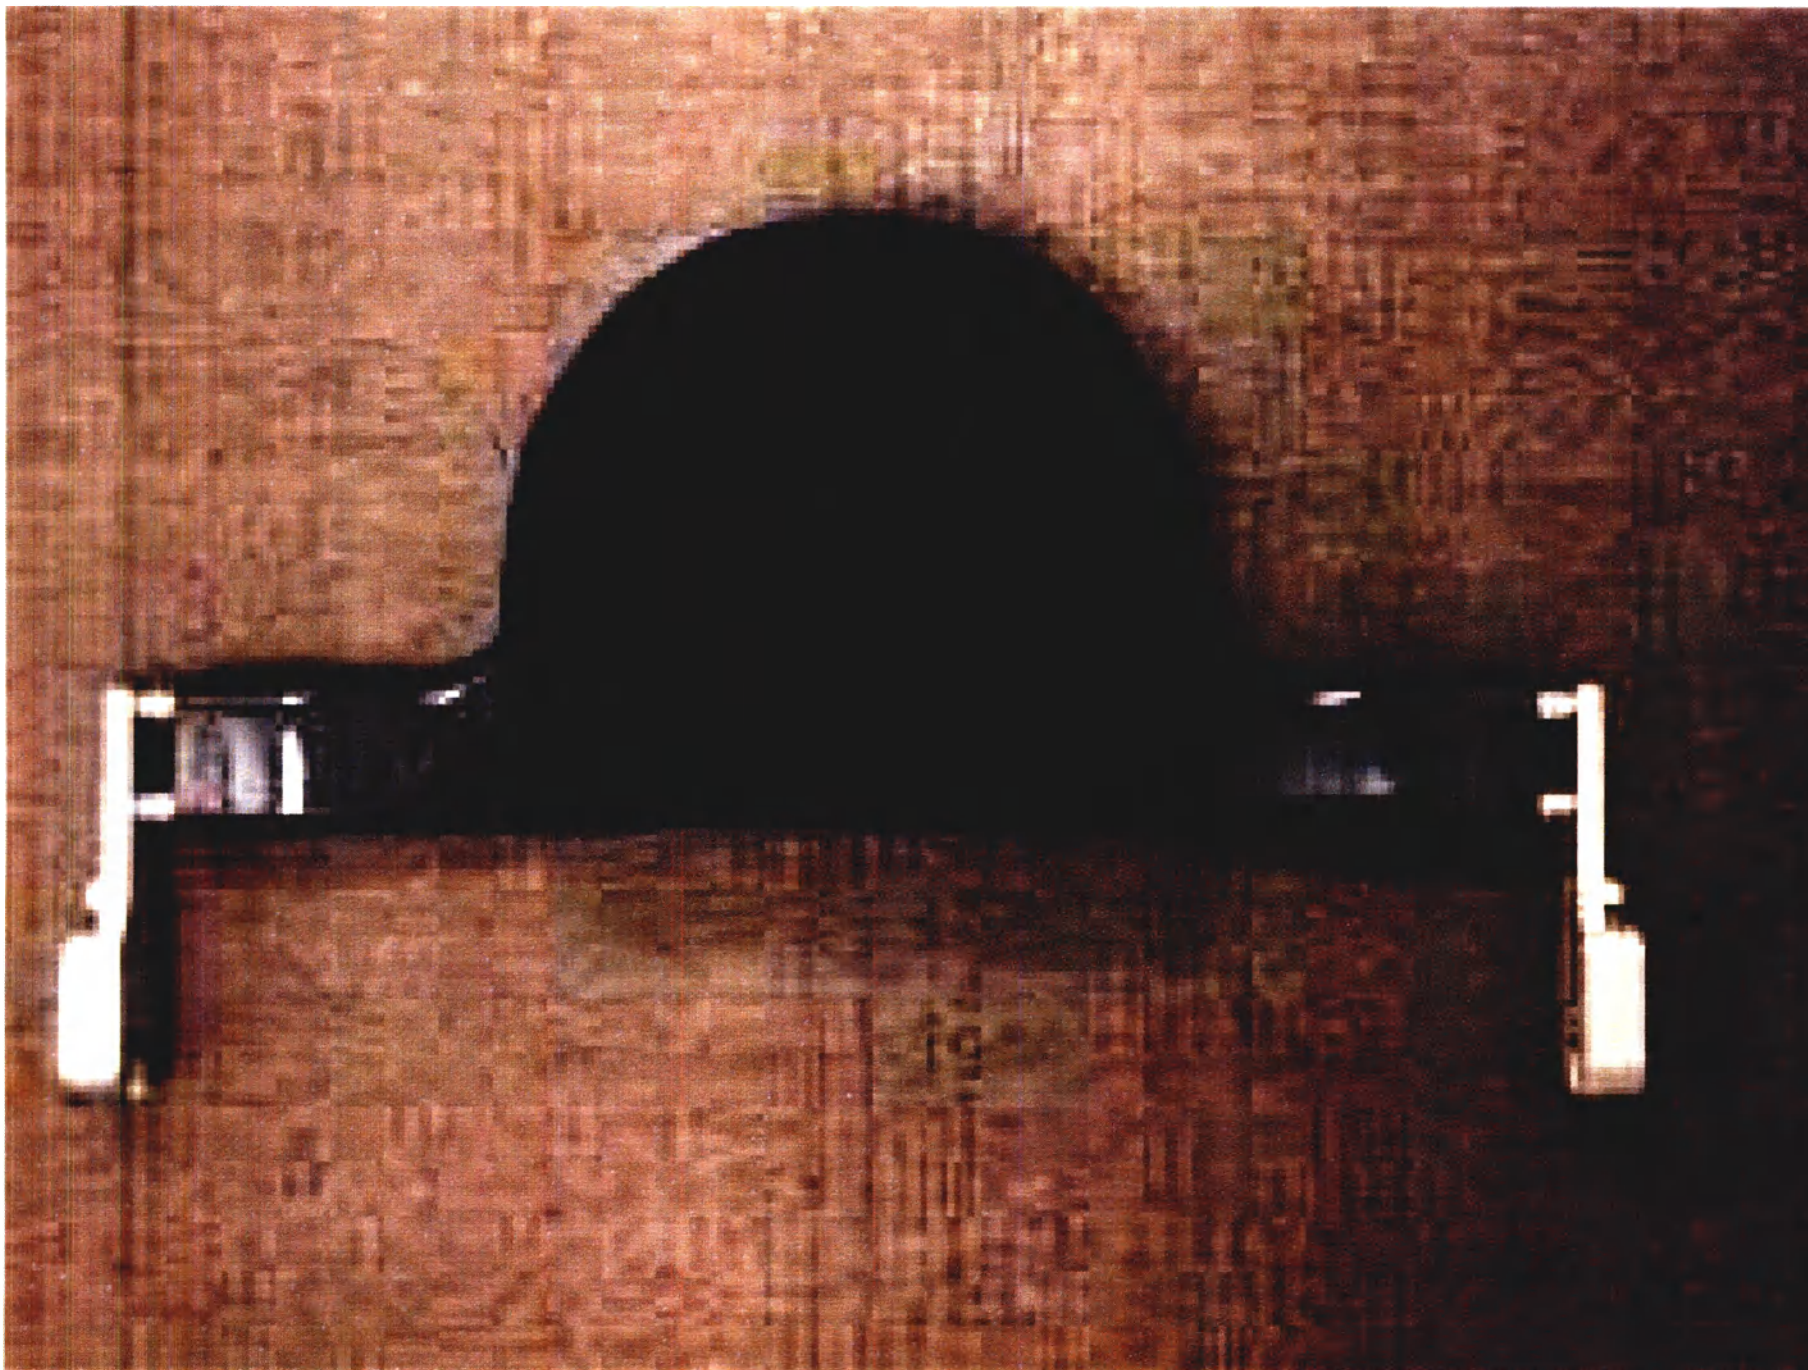


Рисунок 64. Подкладки для подголовника.



Рисунок 65. Ремни для фиксации пациента.



Рисунок 66. Устройства позиционирования пациента.

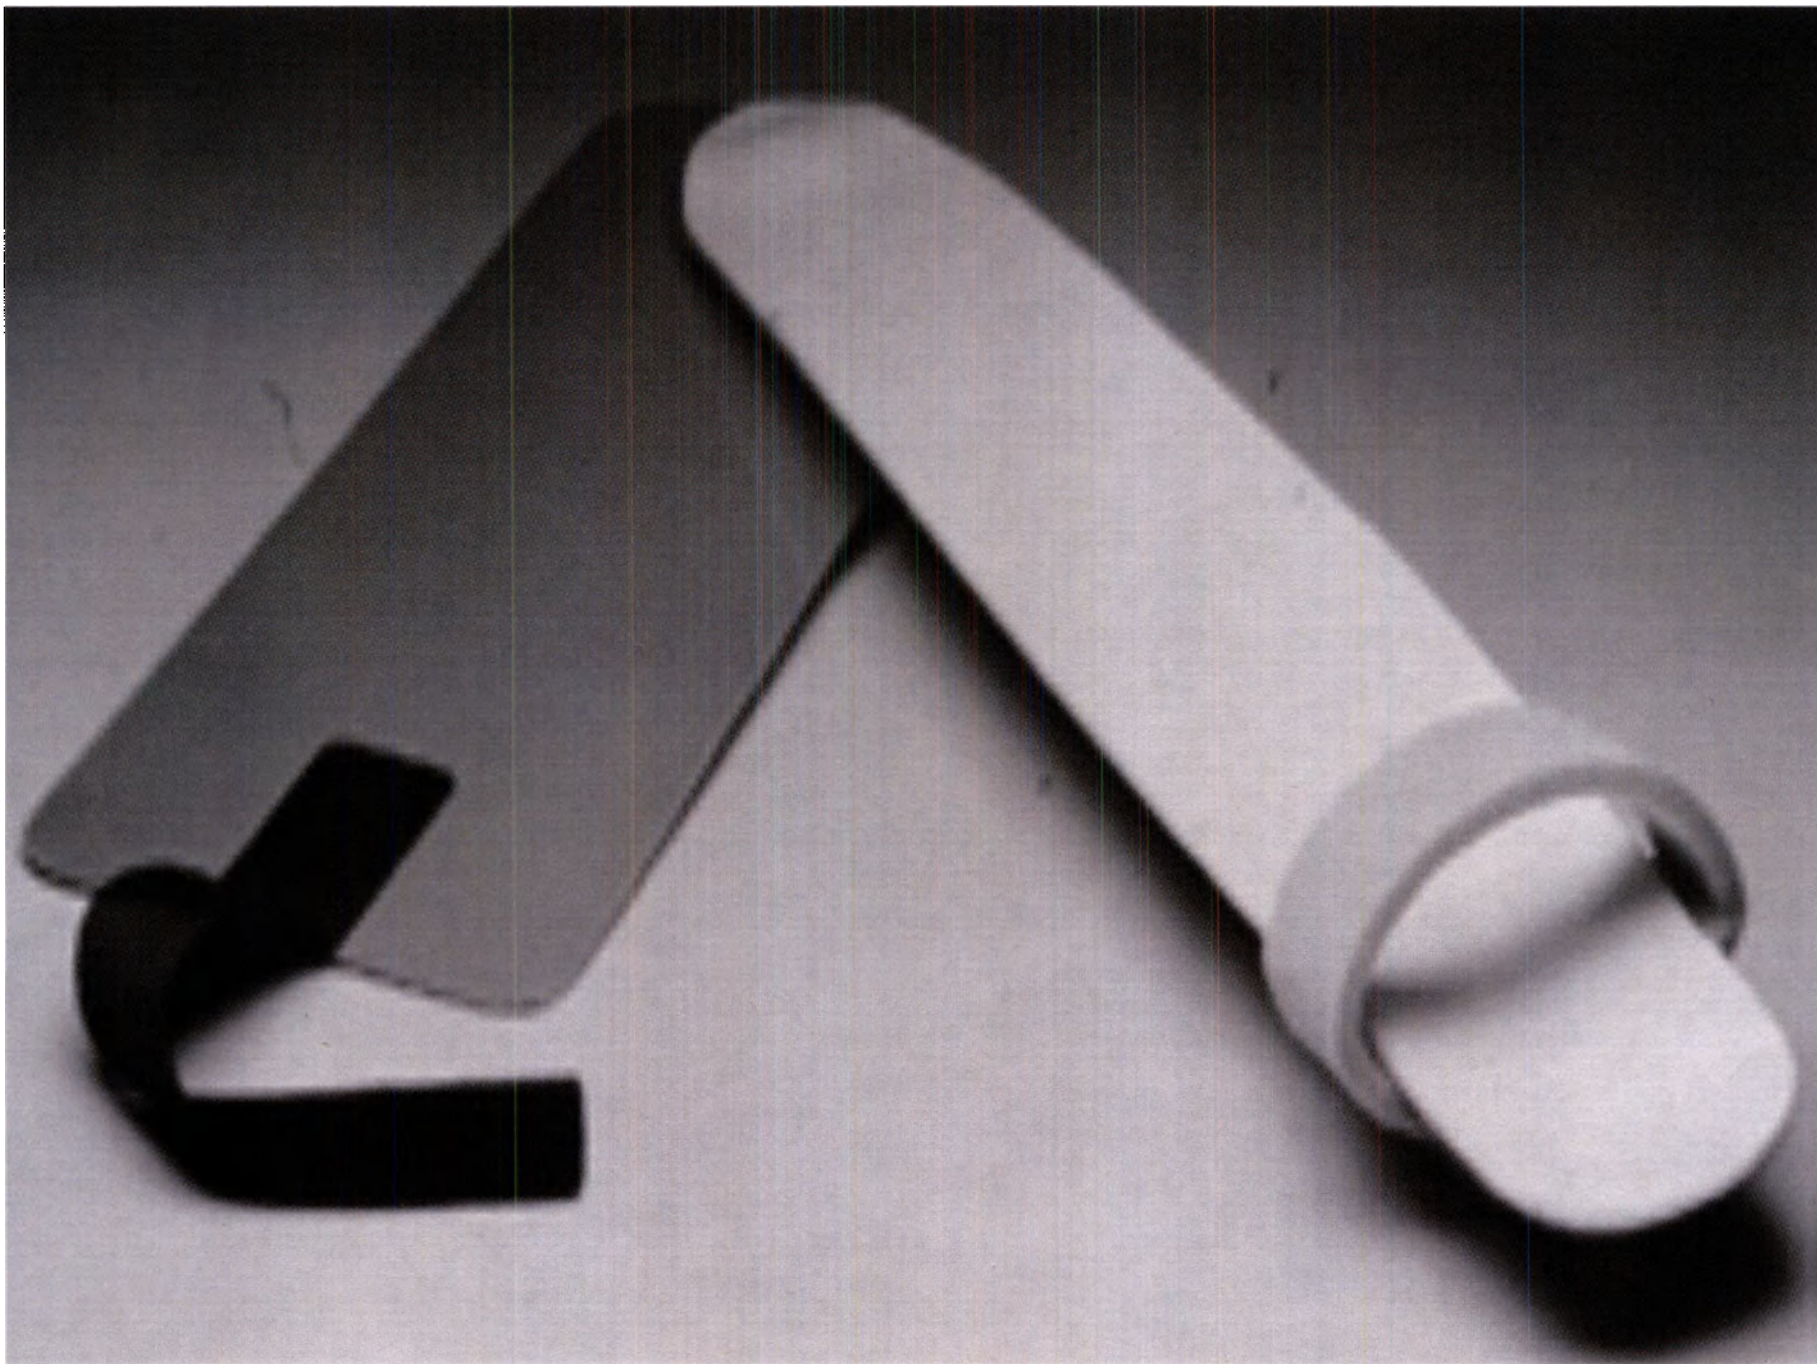


Рисунок 67. Подлокотники для ангиографического стола с накладкой.



GEHC
proprietary

Рисунок 68. Матрасы пациента противопрлежные с чехлом.



Рисунок 69. Стерильные материалы для покрытия узлов аппарата.



Рисунок 70. Стерильные материалы для покрытия узлов аппарата.

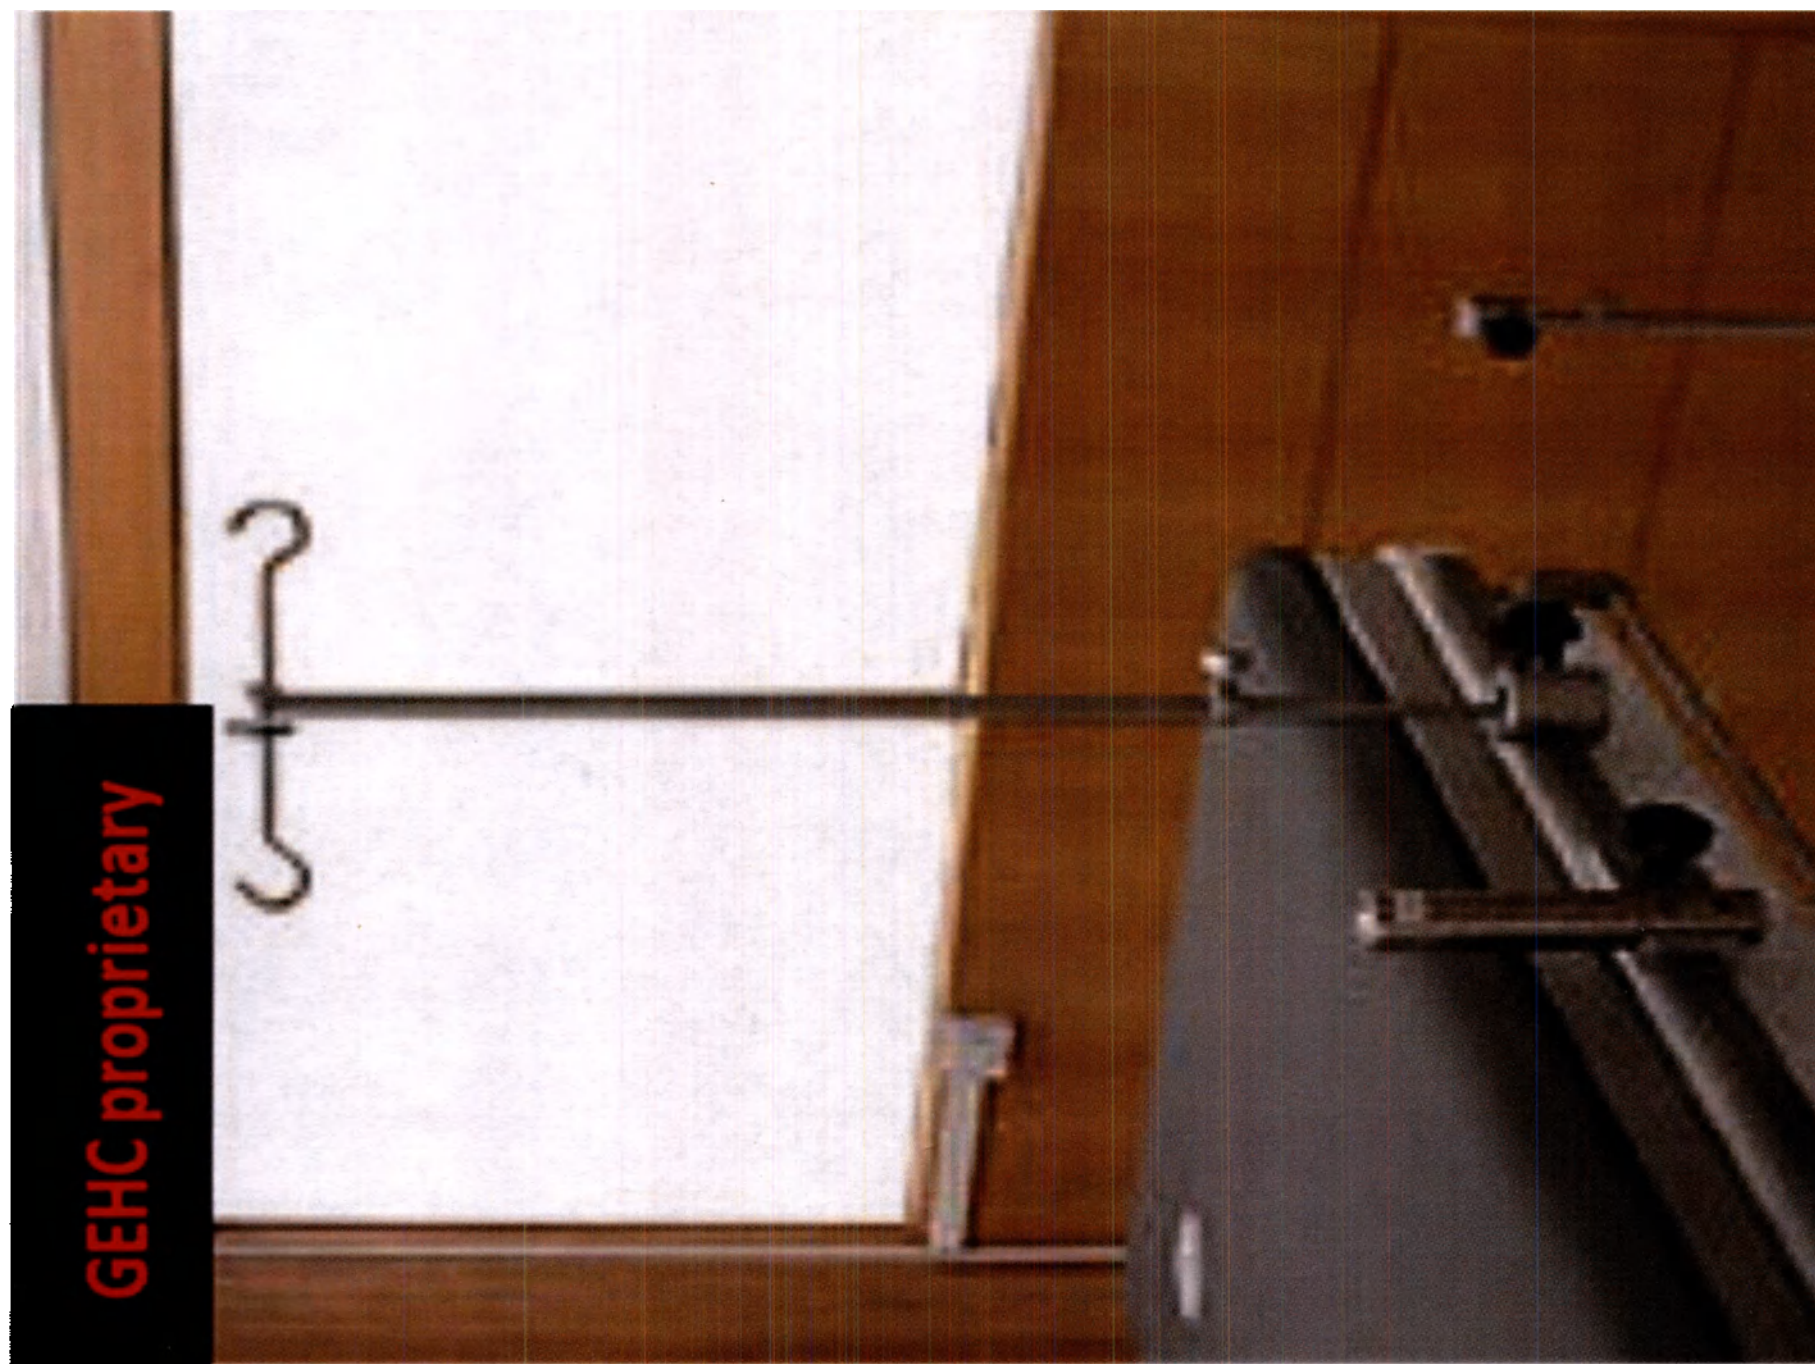


Рисунок 71. Стойка с опорой для внутривенных инъекций.

ГЕНС
proprietary



Рисунок 72. Принтер дозиметрического устройства для распечатки отчета о дозе облучения.

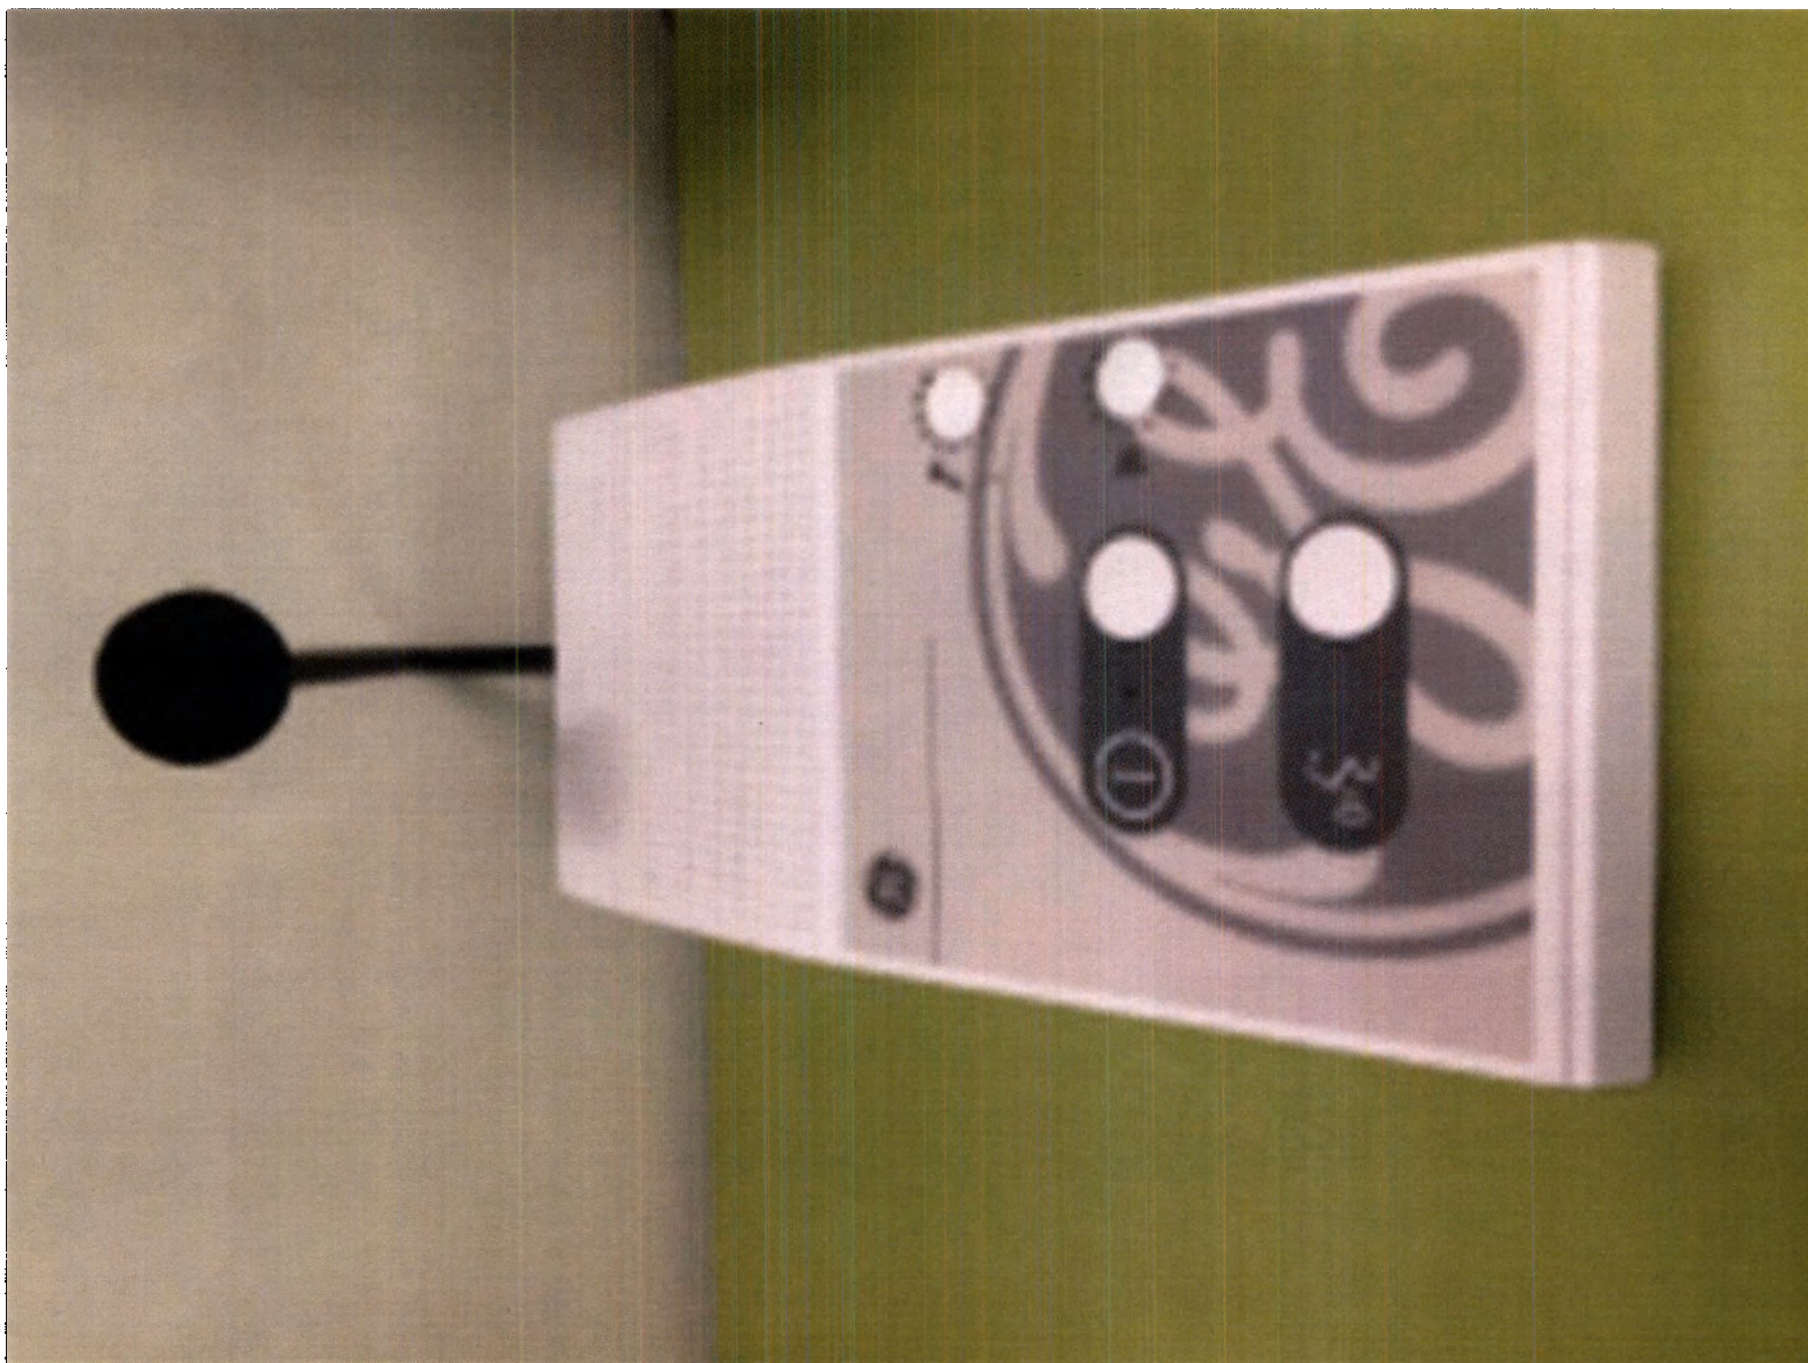


Рисунок 73. Переговорное устройство.



Рисунок 74. Кабель переговорного устройства.



Рисунок 75. Устройство защиты от соударений между элементами ангиографической системы и пациентом.

GEHC proprietary

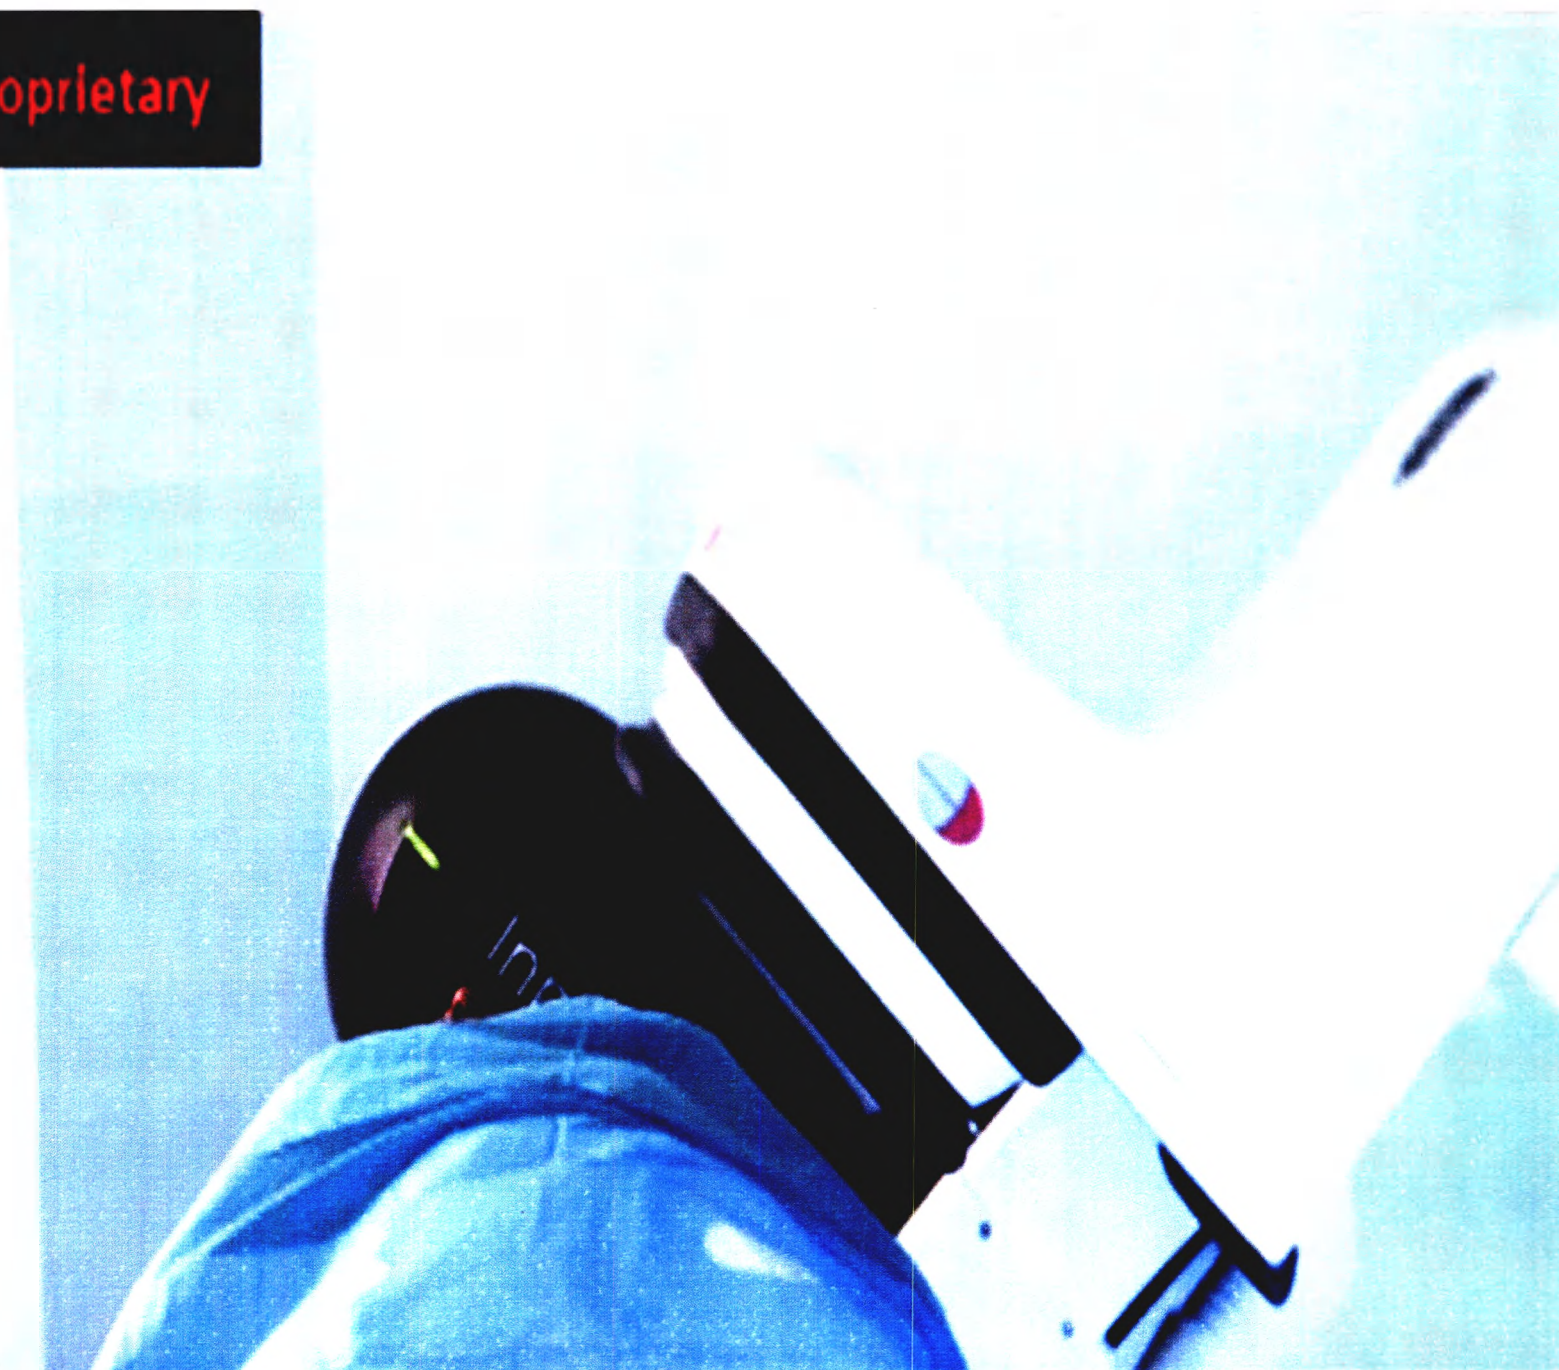


Рисунок 76. Бесконтактная система защиты от столкновений с пациентом (InnovaSense).

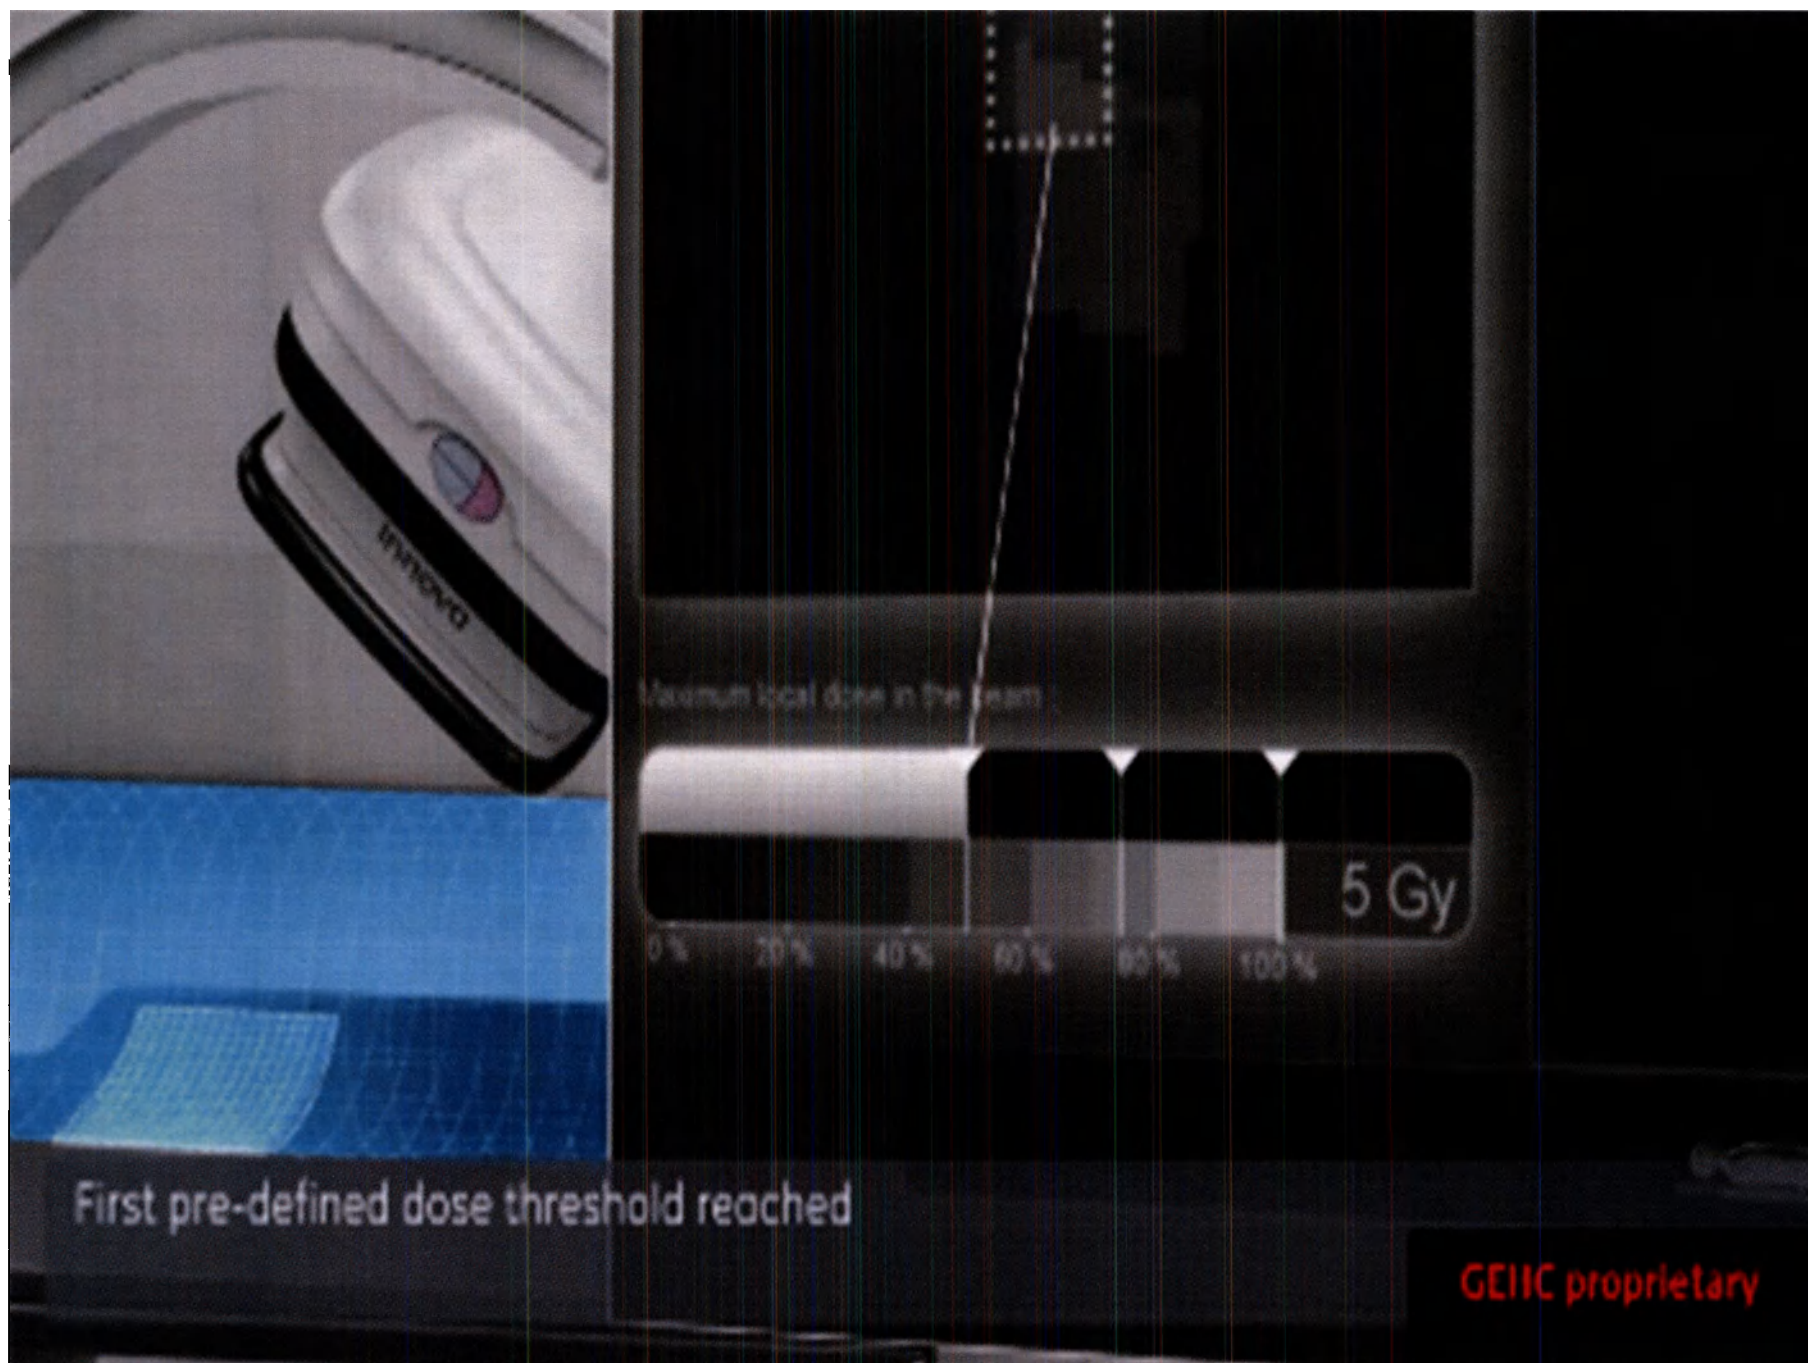


Рисунок 77. Бесконтактная система защиты от столкновений с пациентом (DoseMap).

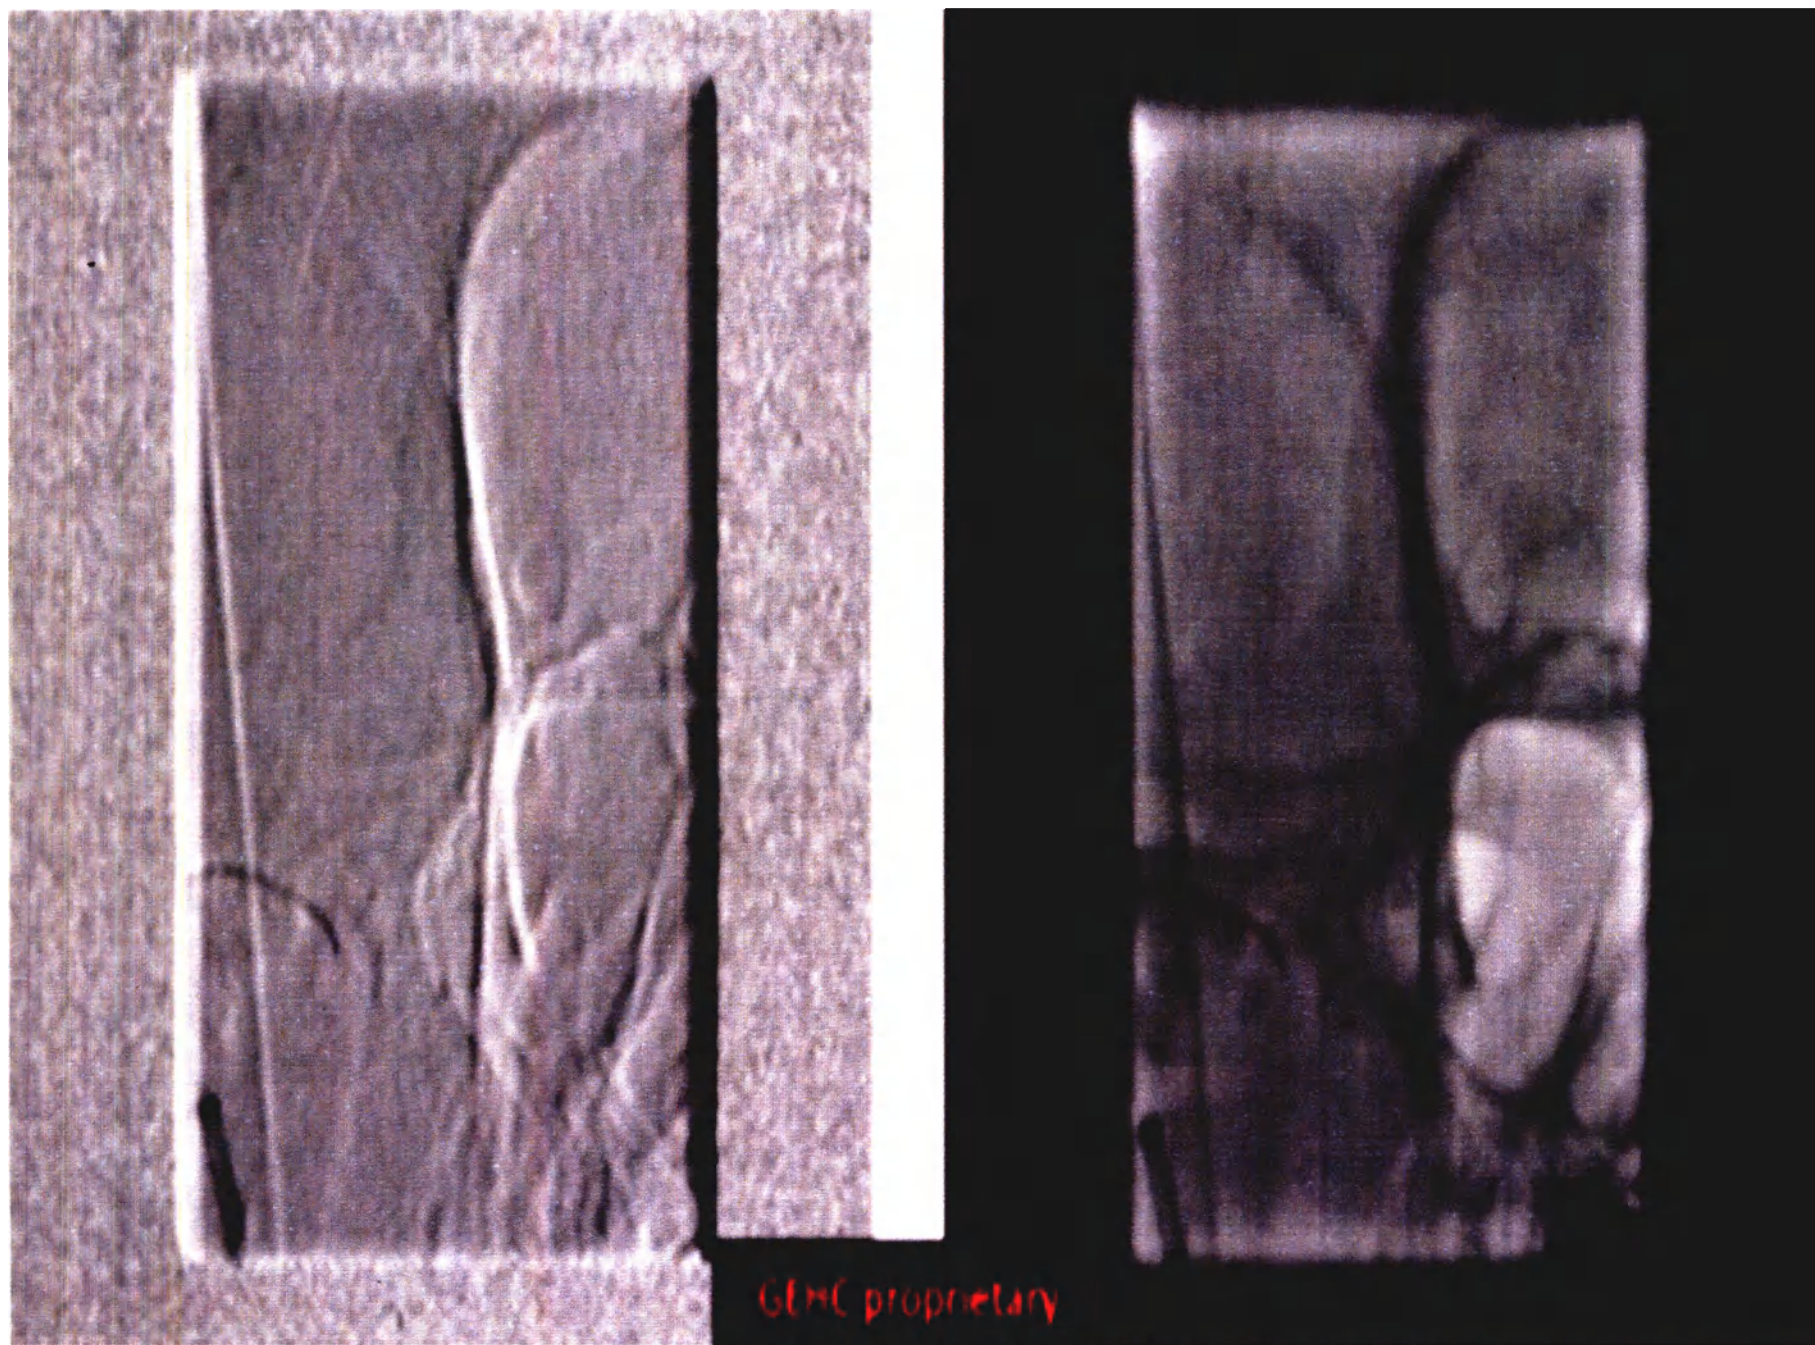


Рисунок 78. Модуль одновременного отображения субтрагированных и несубтрагированных изображений.

ГЕНС proprietary

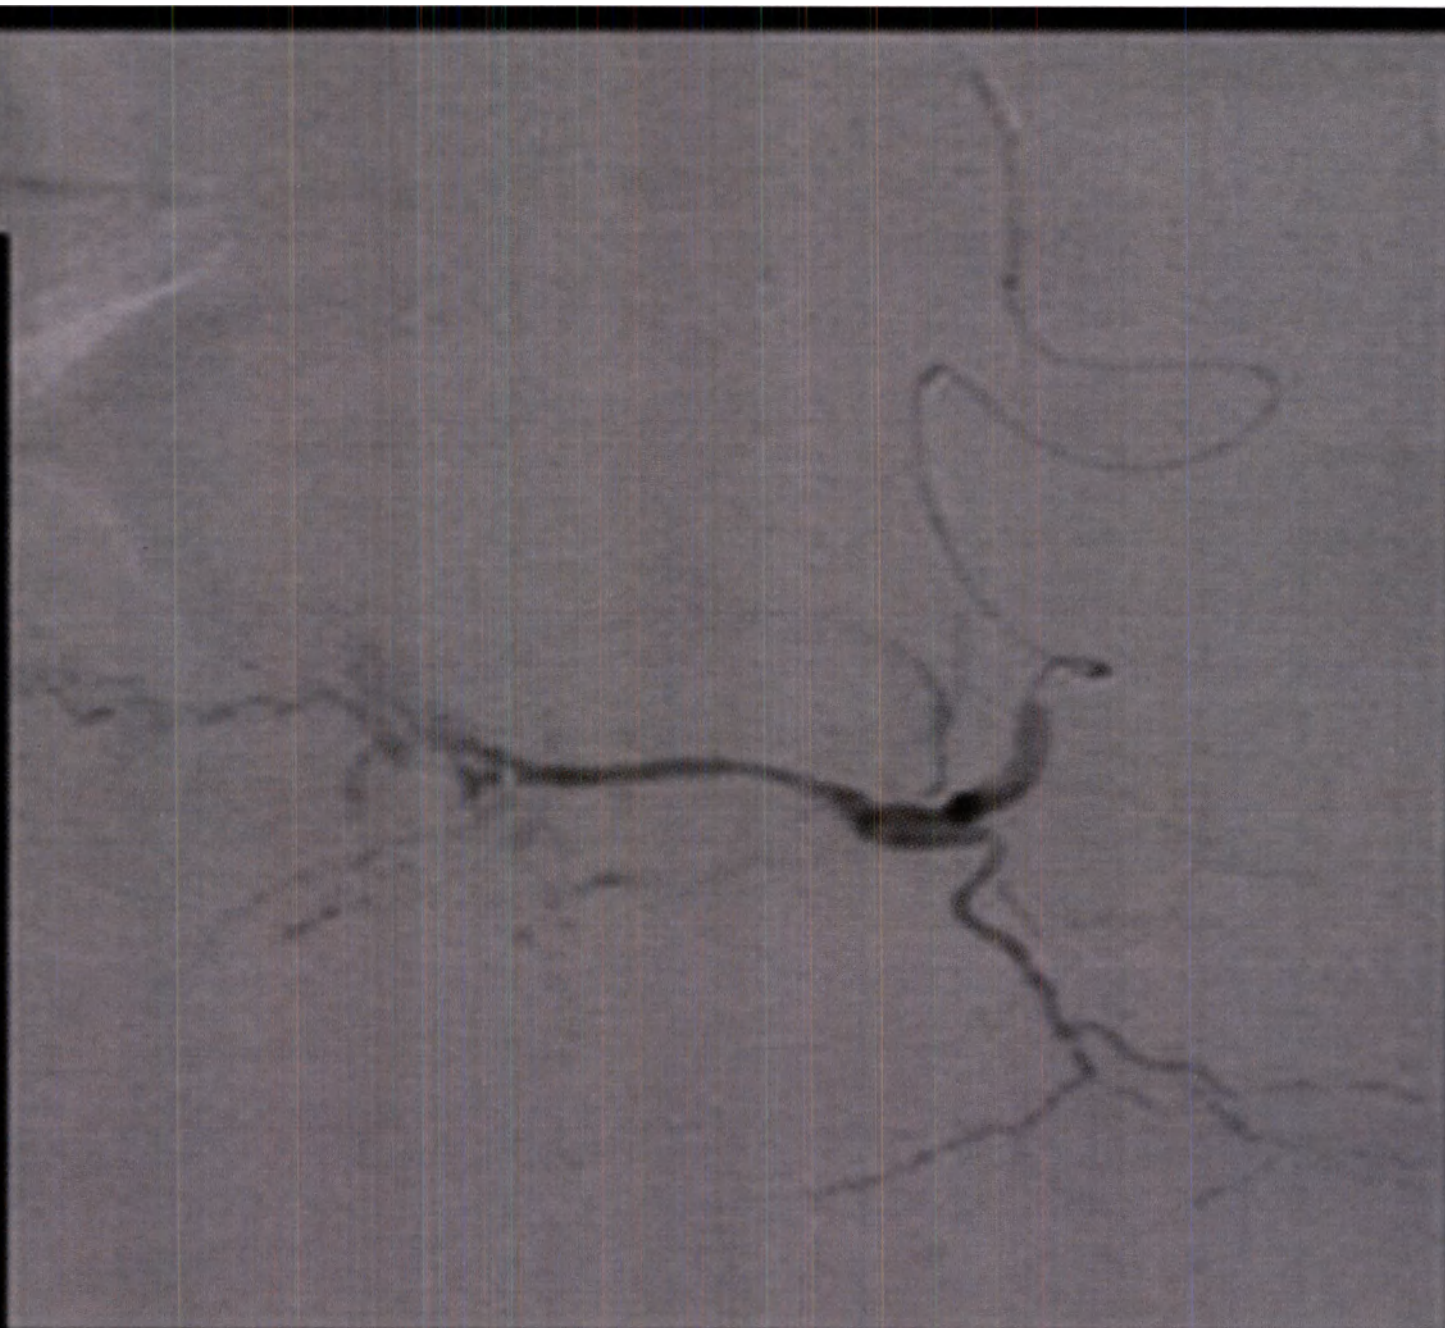


Рисунок 79. Программный модуль двухмерной навигации Blended Roadmap.



GEHC proprietary

Рисунок 80. Программный модуль получения трехмерных субтрагированных изображений.

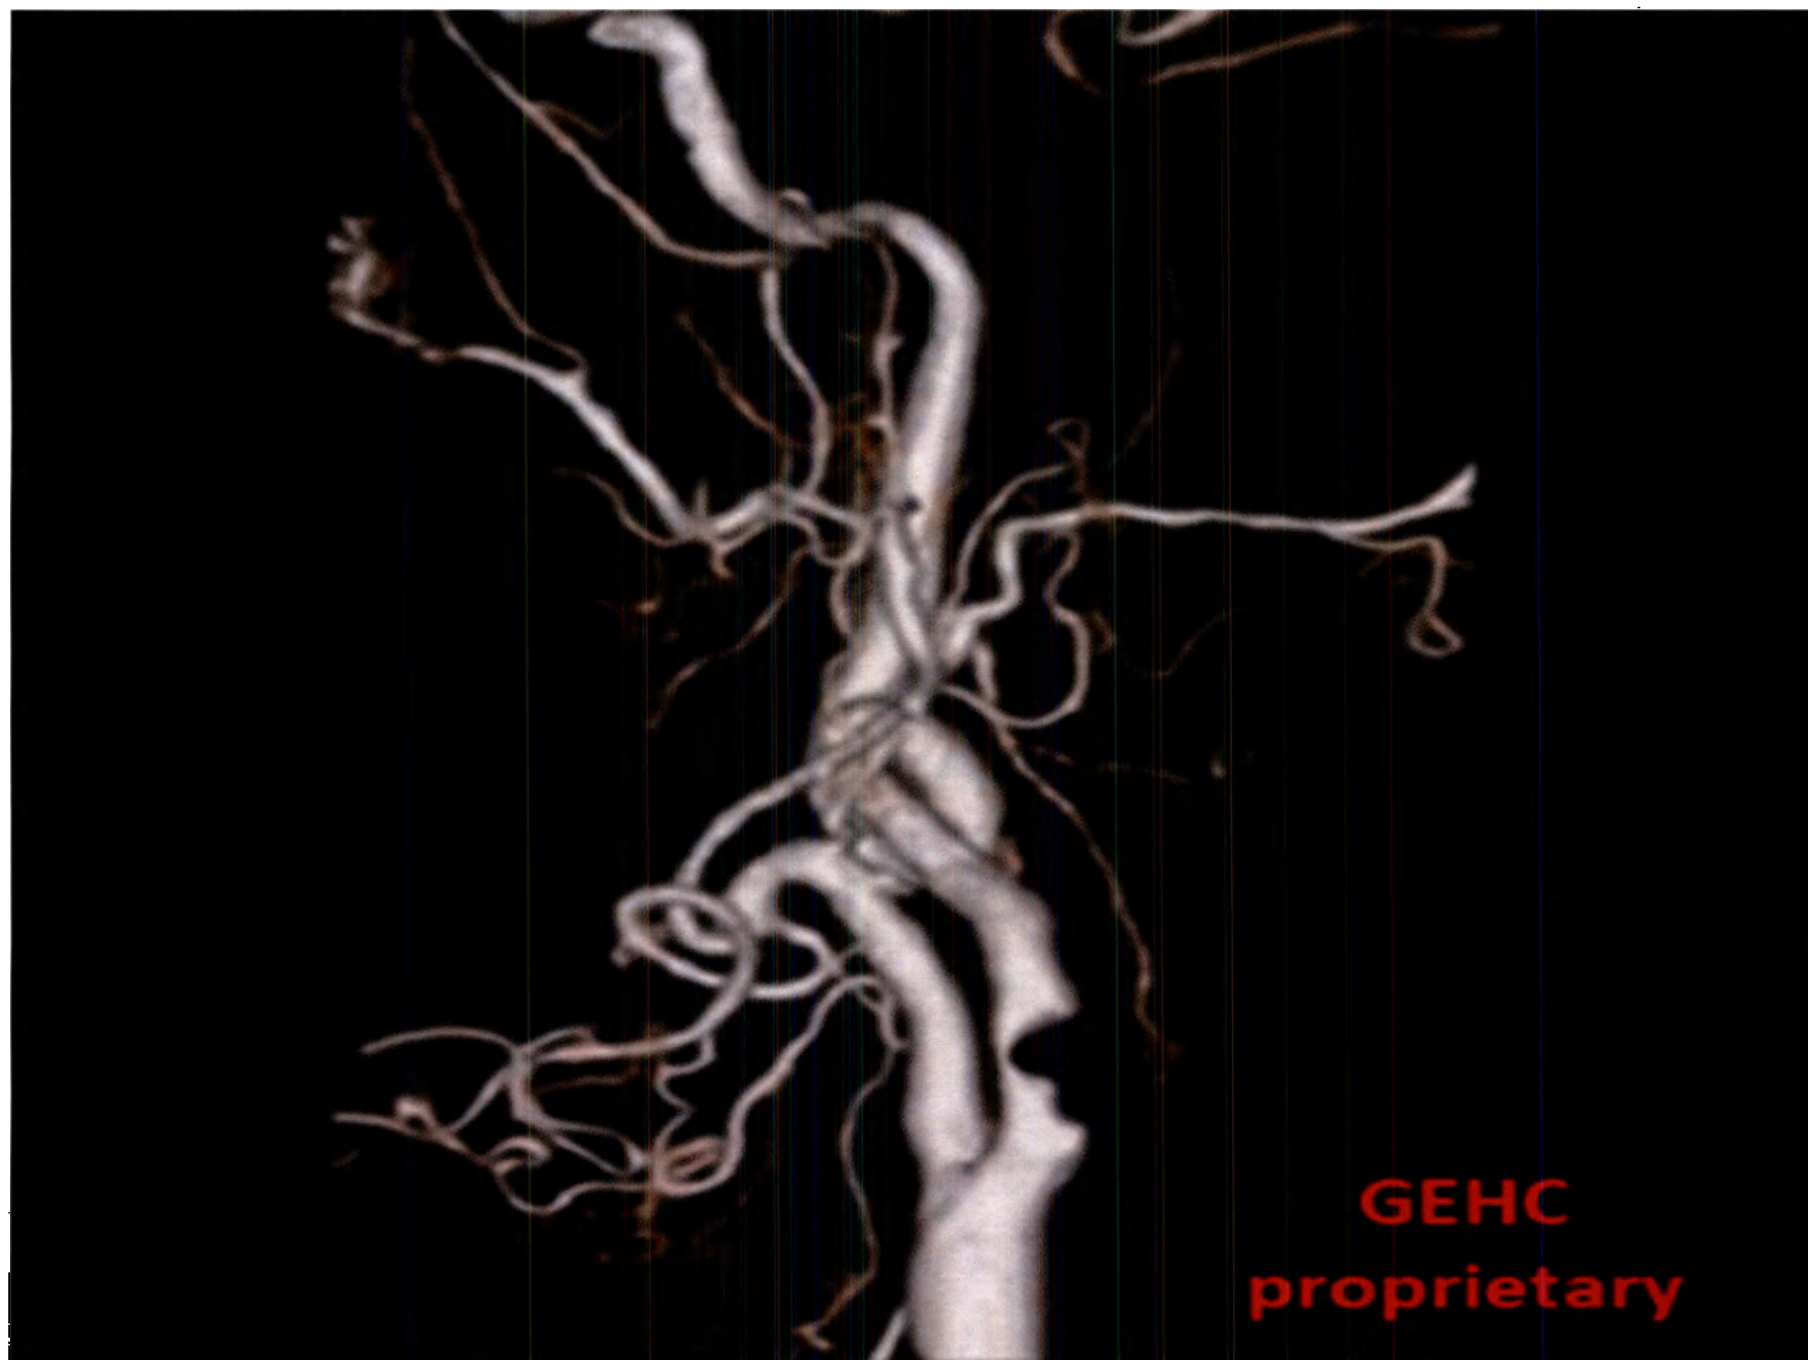


Рисунок 81. Программный модуль получения трехмерного изображения.



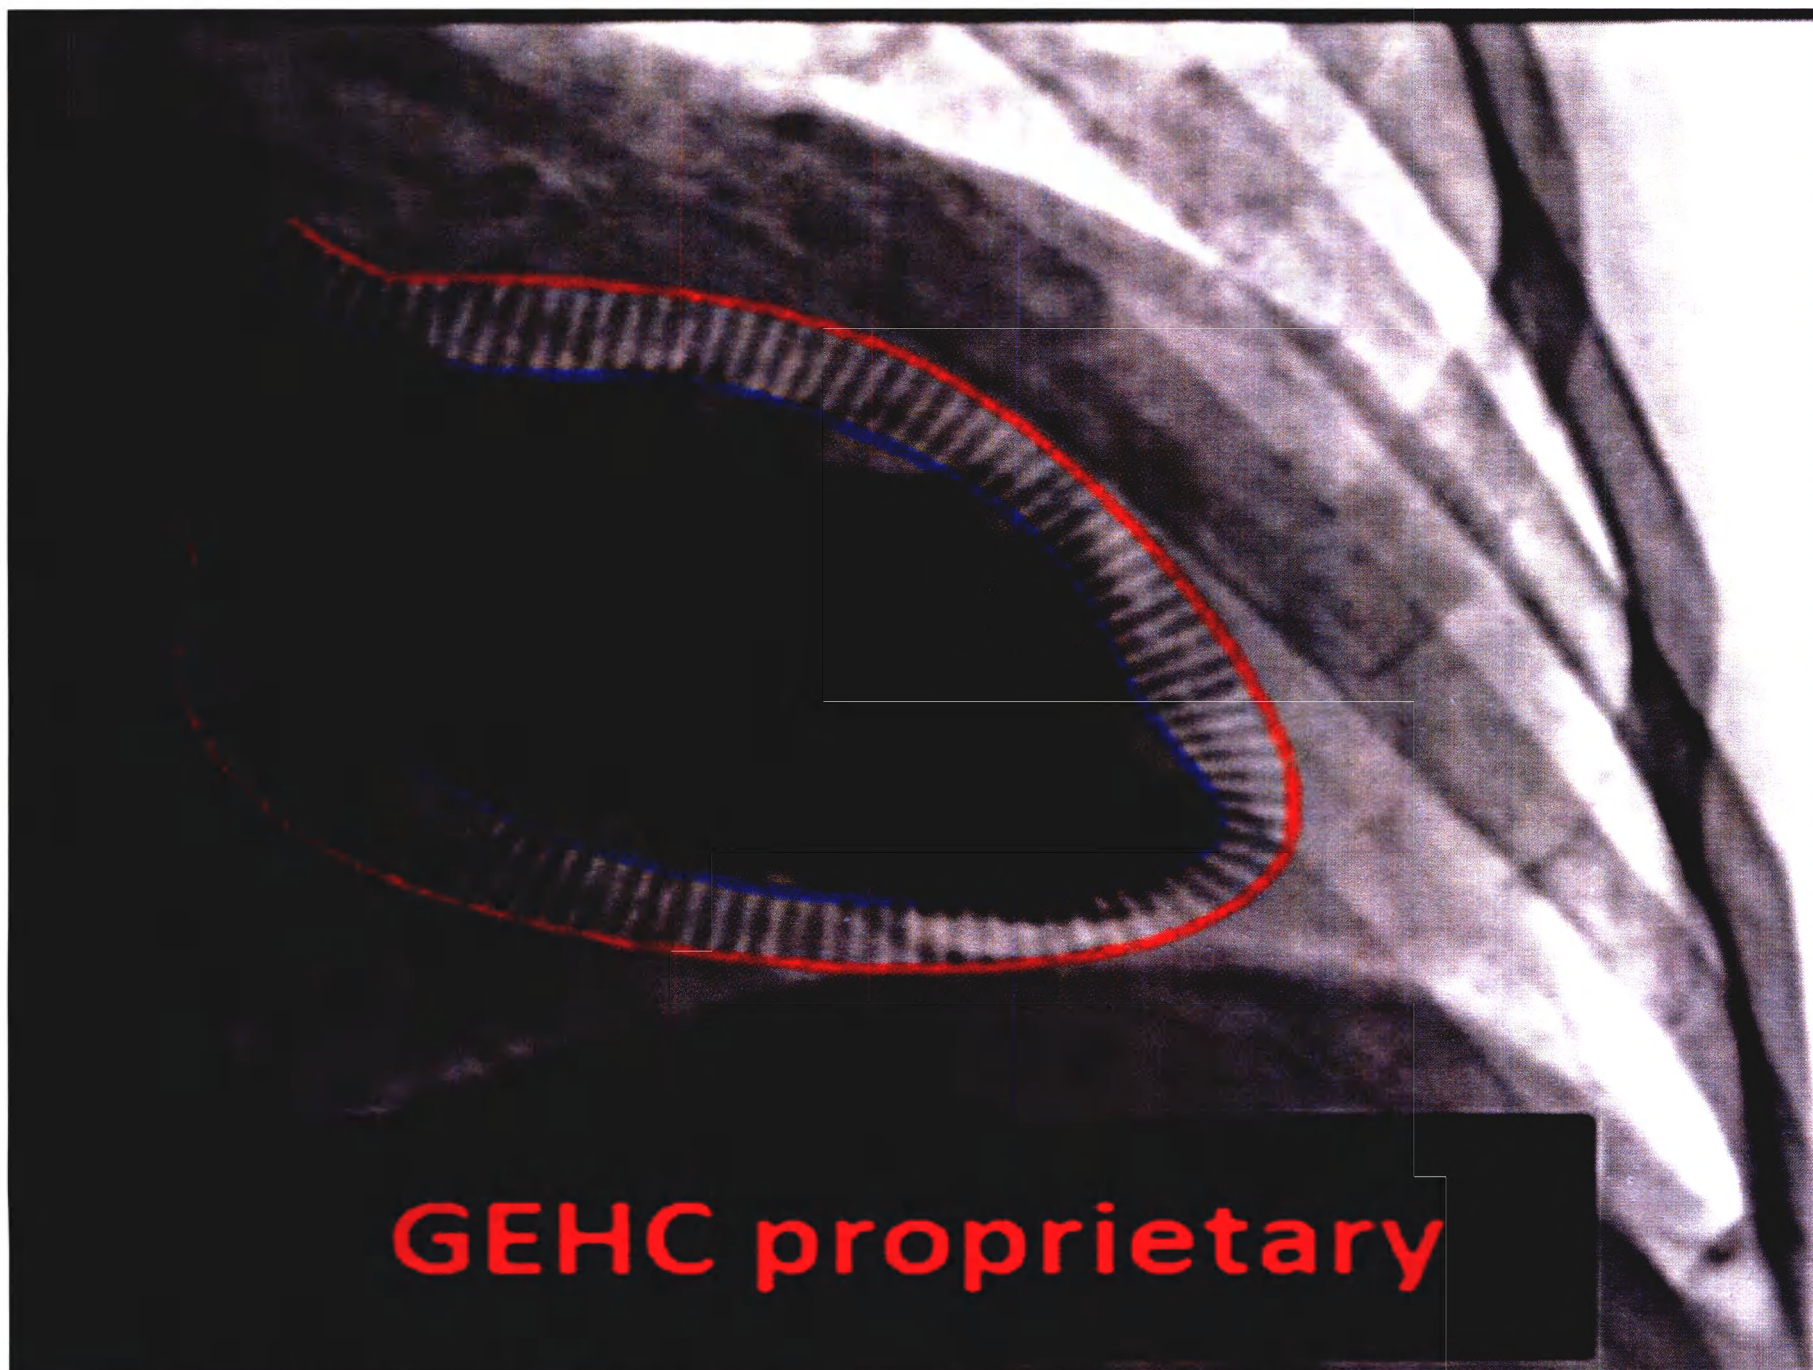


Рисунок 82. Программный модуль кардиологического анализа, включающий анализ стеноза и анализ левого желудочка.

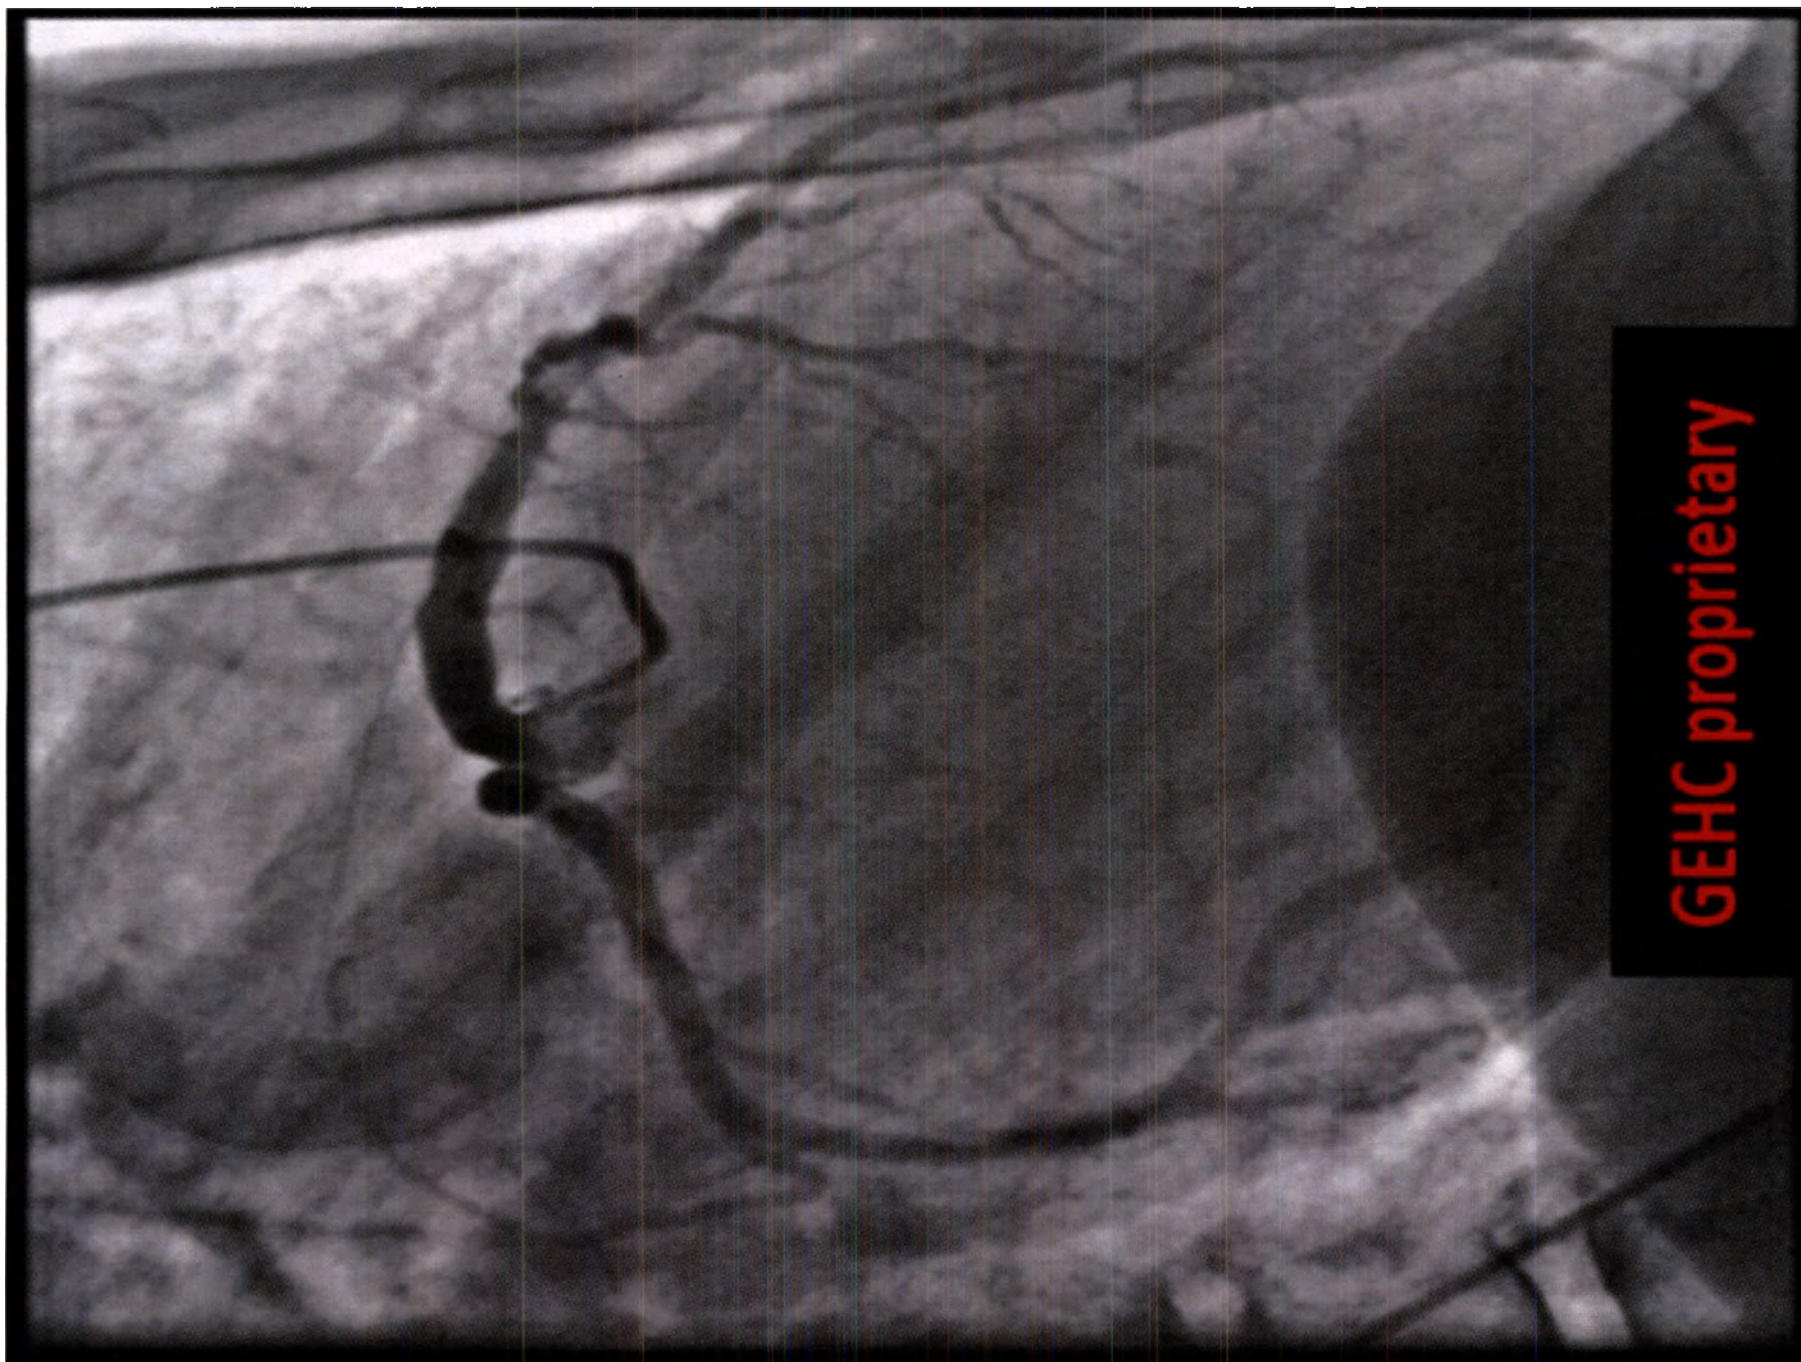

GEHC proprietary

Рисунок 83. Программный модуль INNOVA SPIN для ротационной ангиографии.

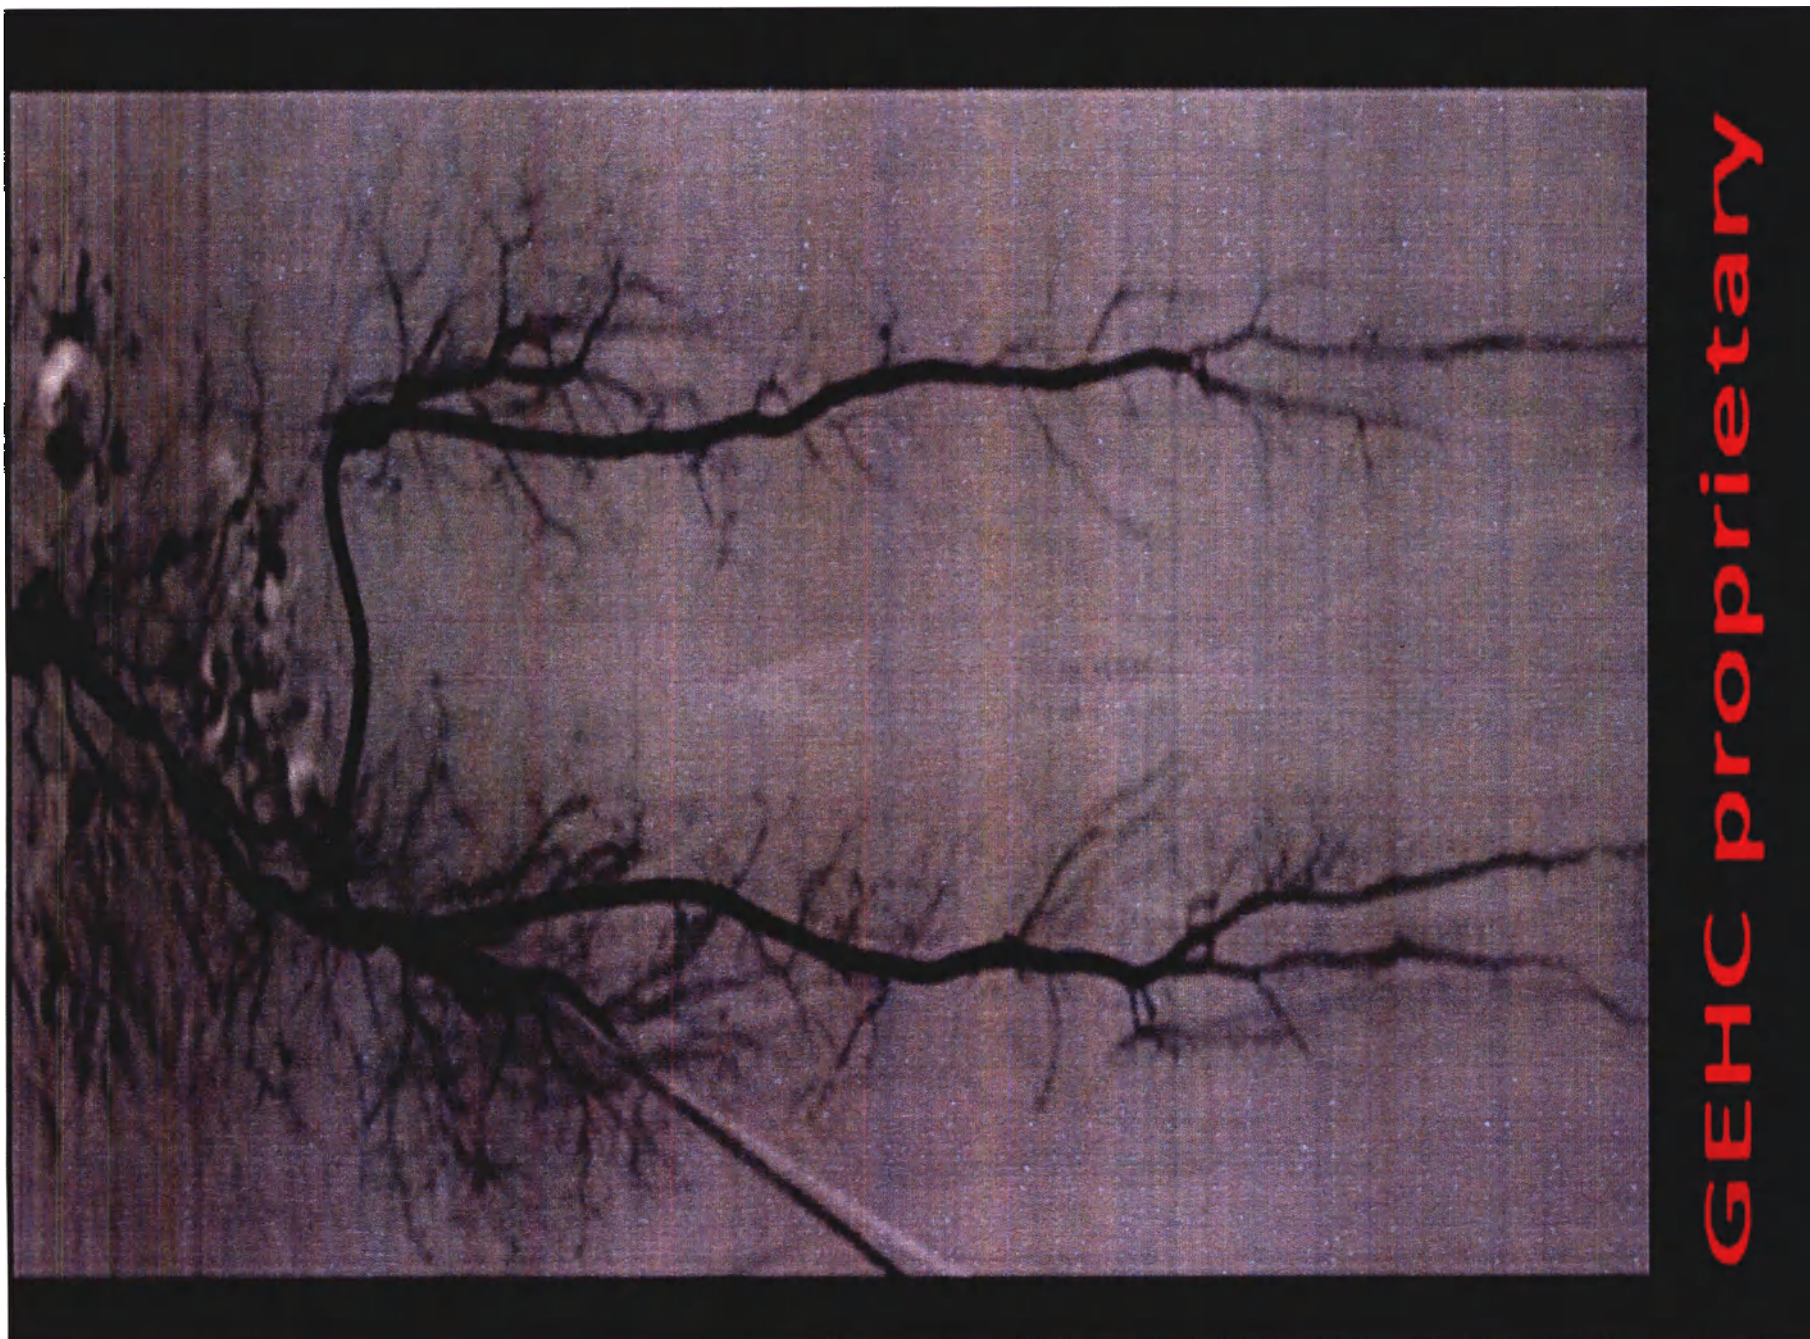

GENC proprietary

Рисунок 84. Программный модуль INNOVA BREEZE для отслеживания болюса контрастного вещества на всем протяжении сосуда с субтракцией.

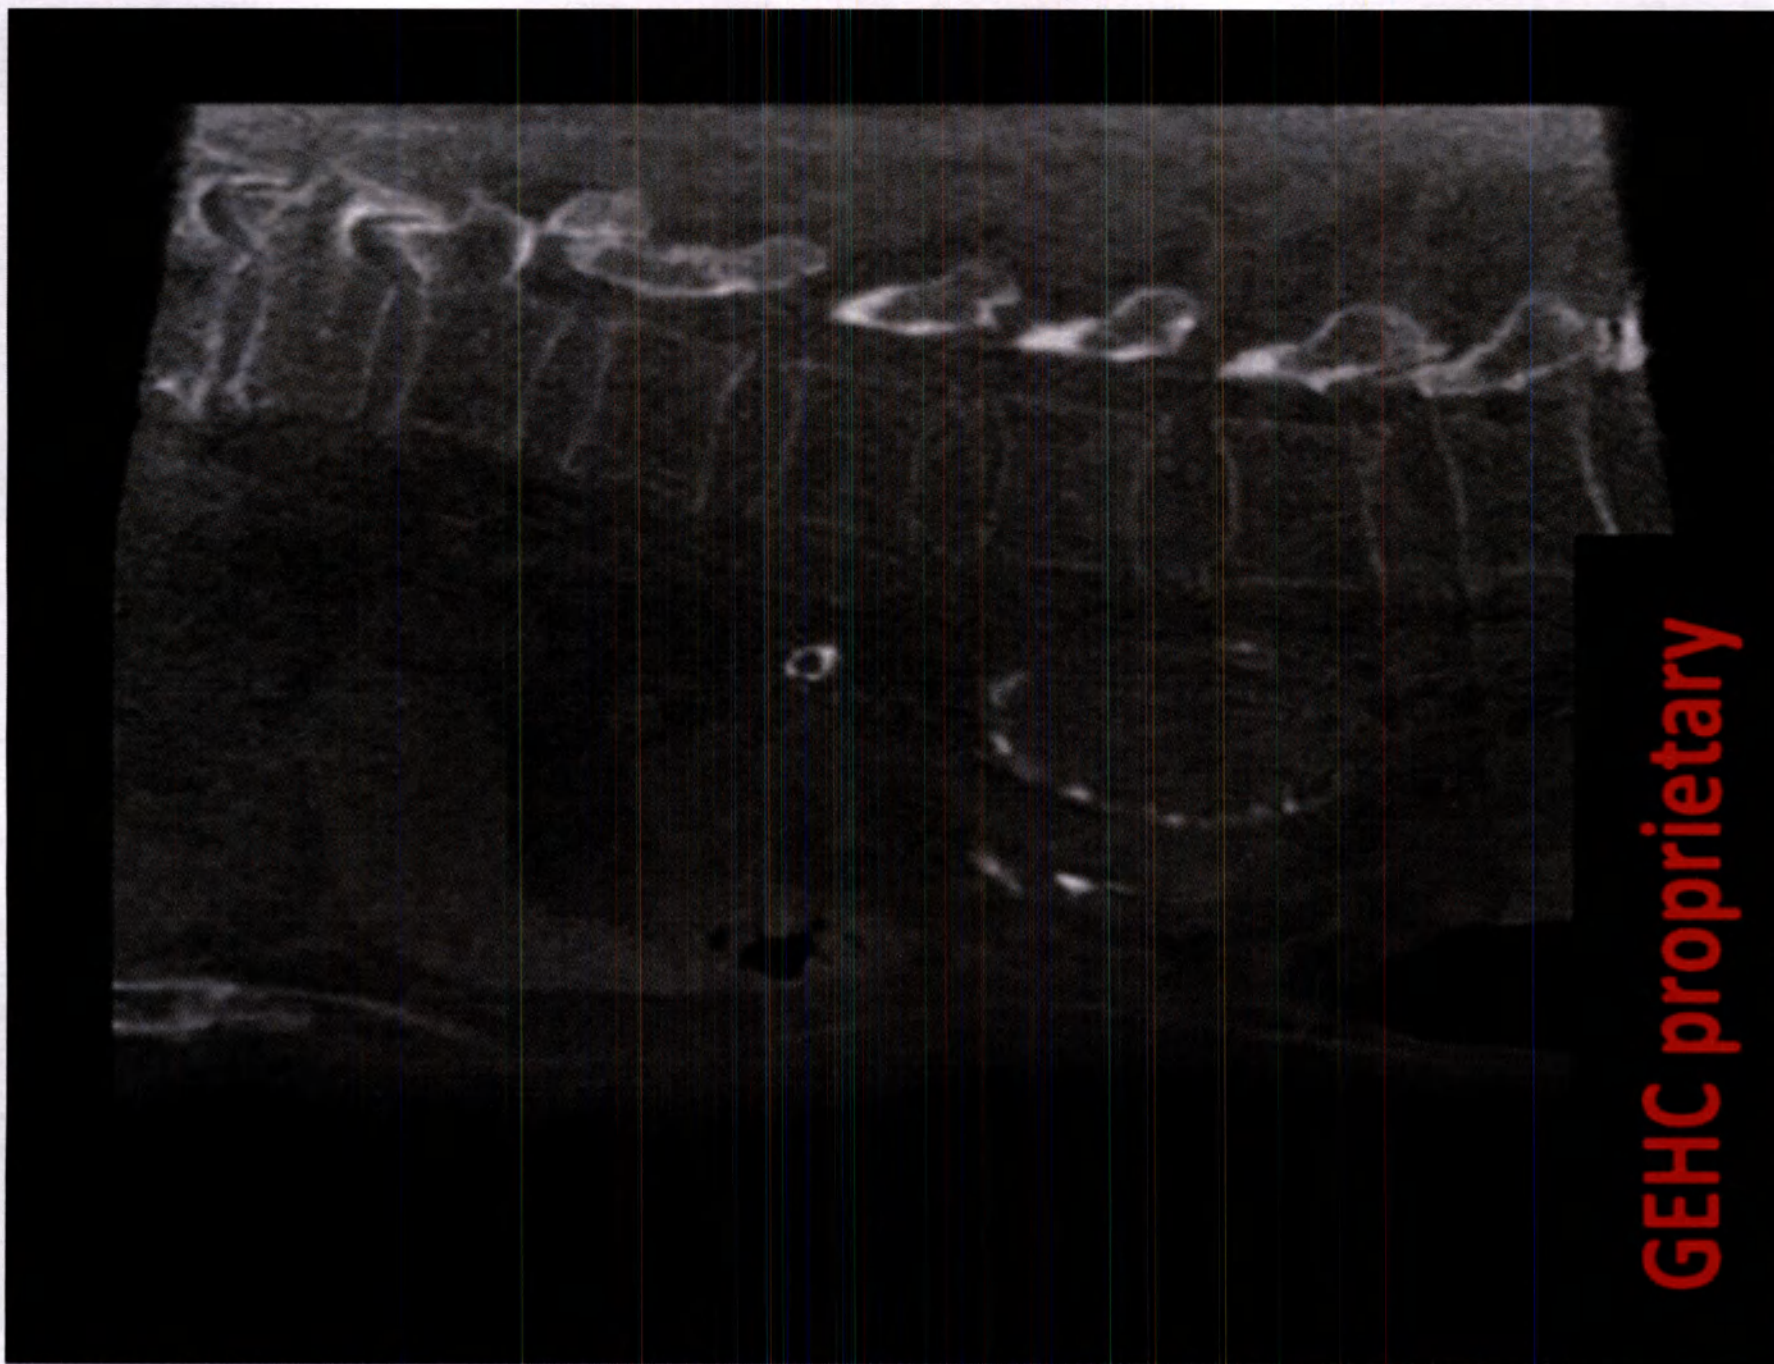


Рисунок 85. Программный модуль получения трехмерных изображений с улучшенной визуализацией мягких и костных тканей 3D CT HD.


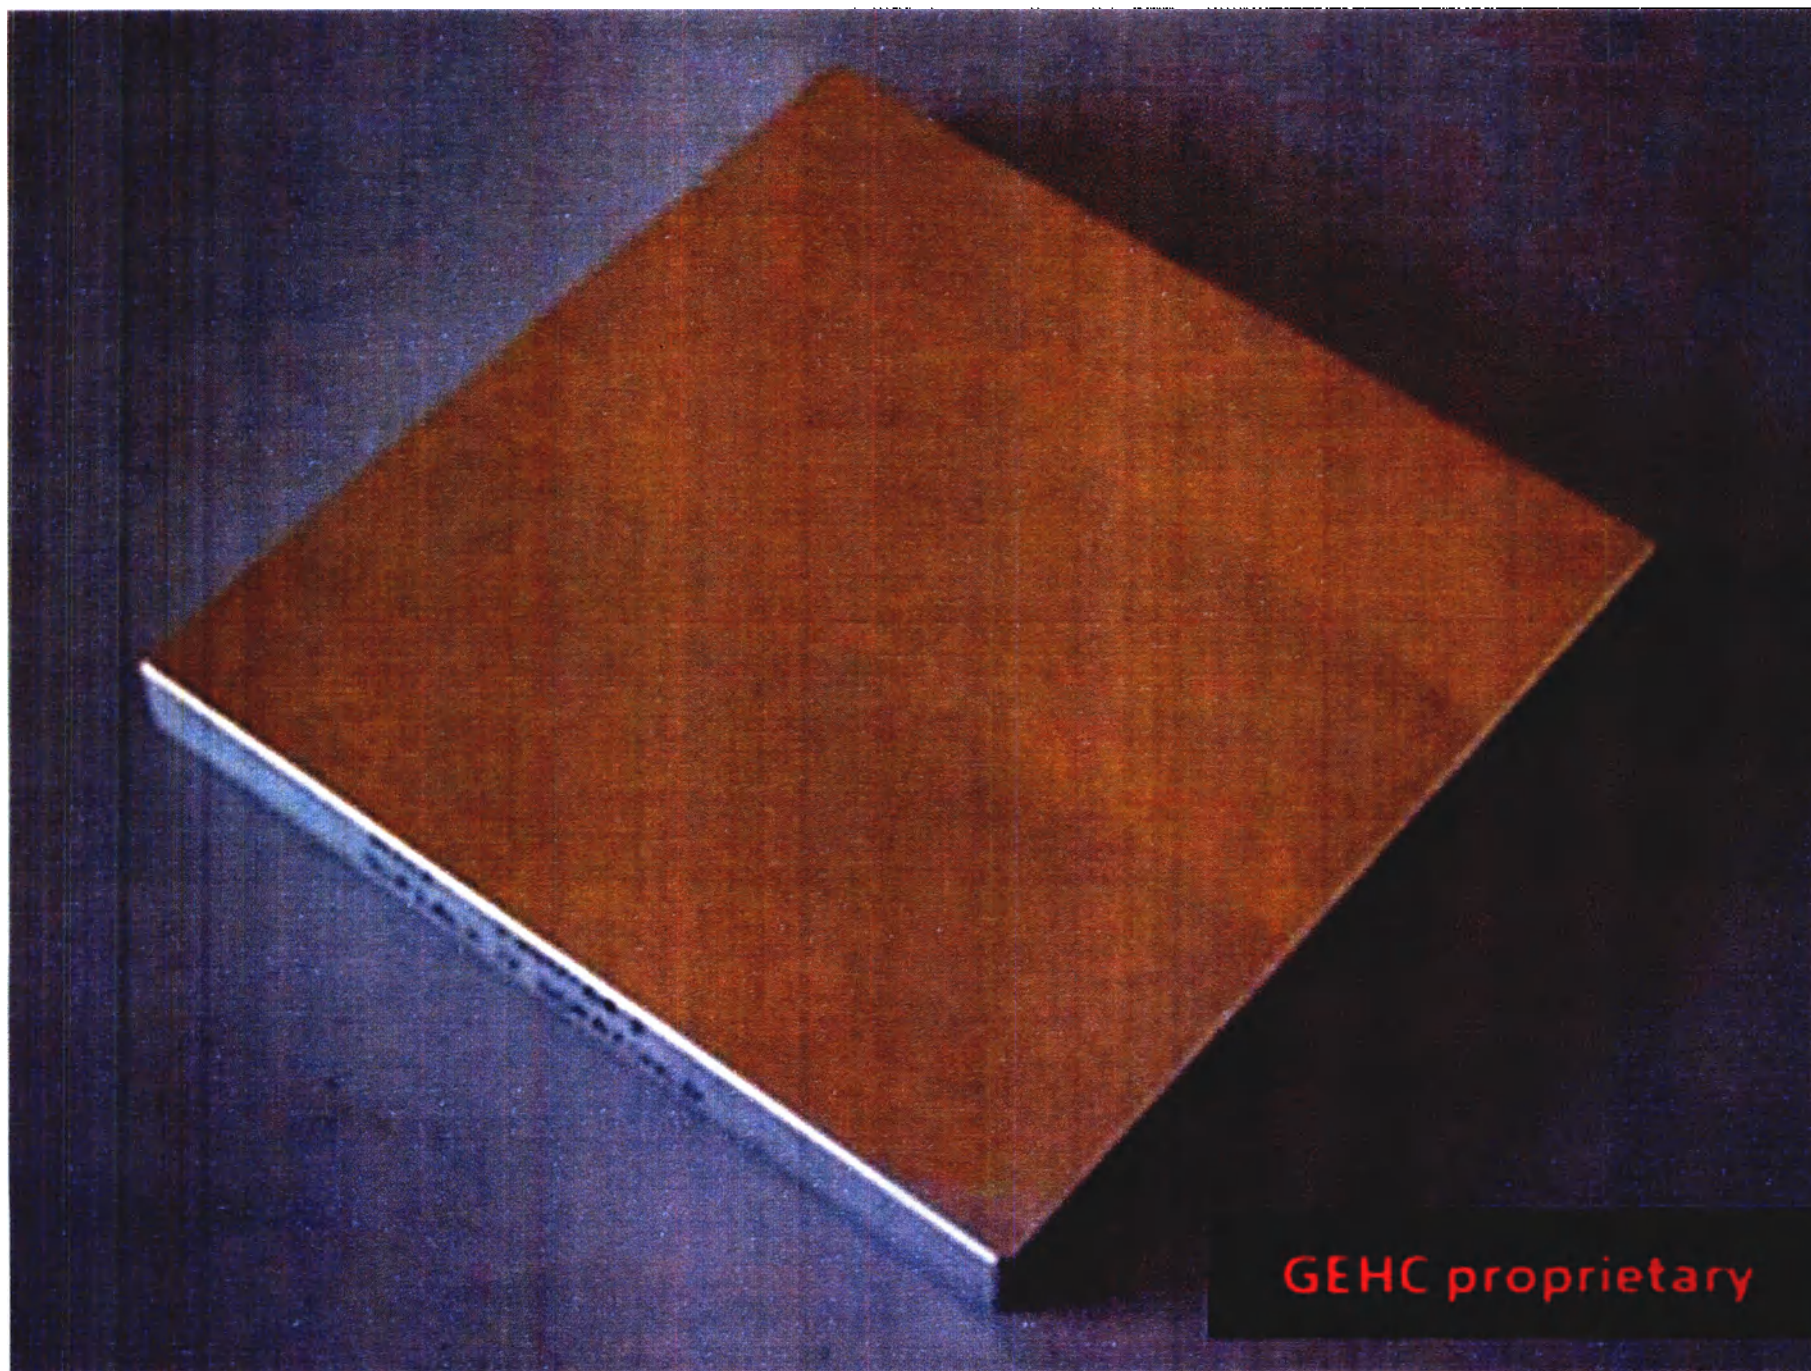


Рисунок 86. Фантомы для калибровки. Щелевой фантом.

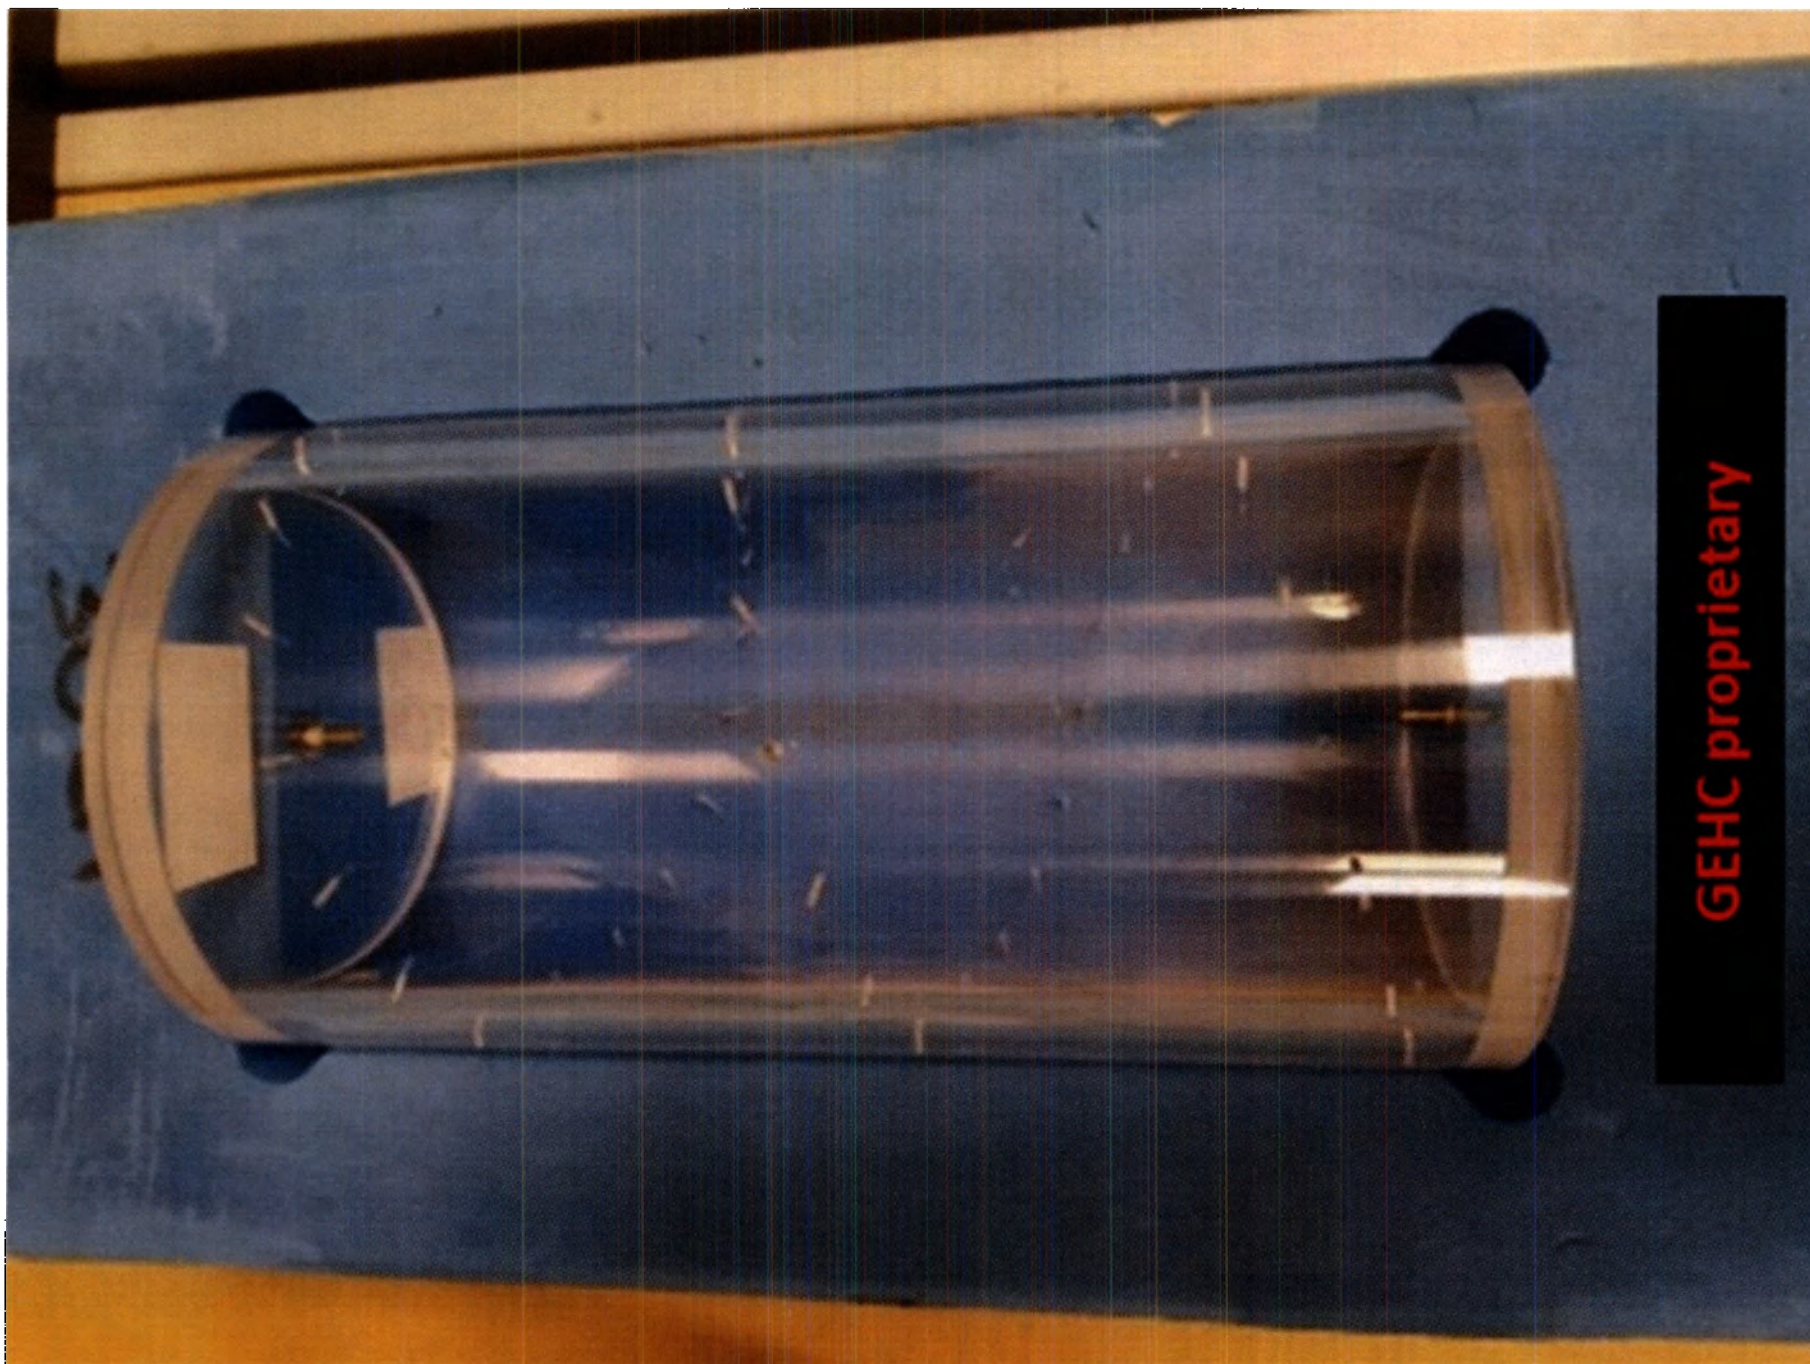

GEHC proprietary

Рисунок 87. Фантомы для калибровки. Фантом для 3D-калибровки.

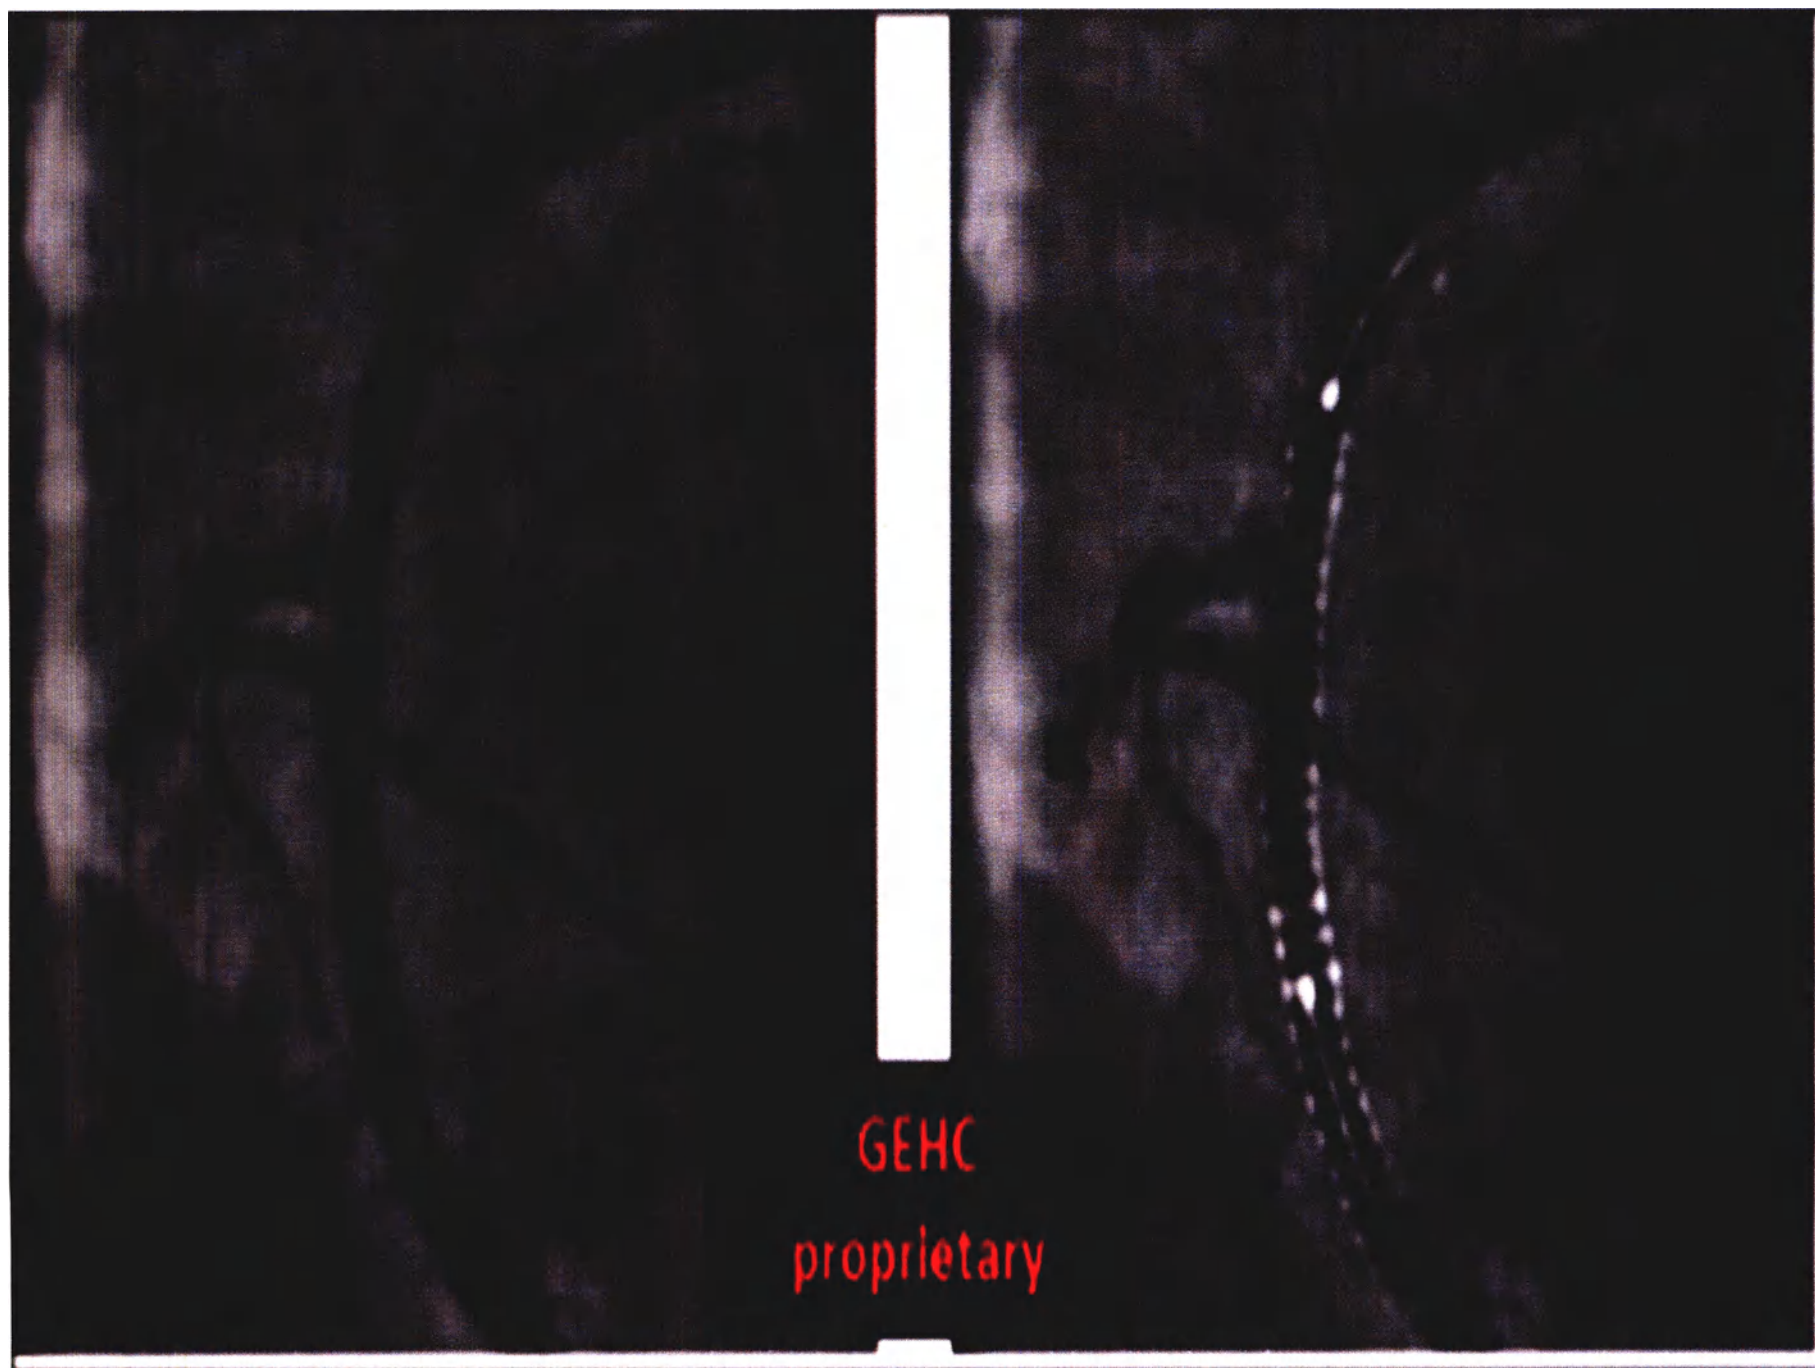


Рисунок 88. Программный модуль улучшенной визуализации стентов и высококонтрастной рентгеноскопии PCI ASSIST.

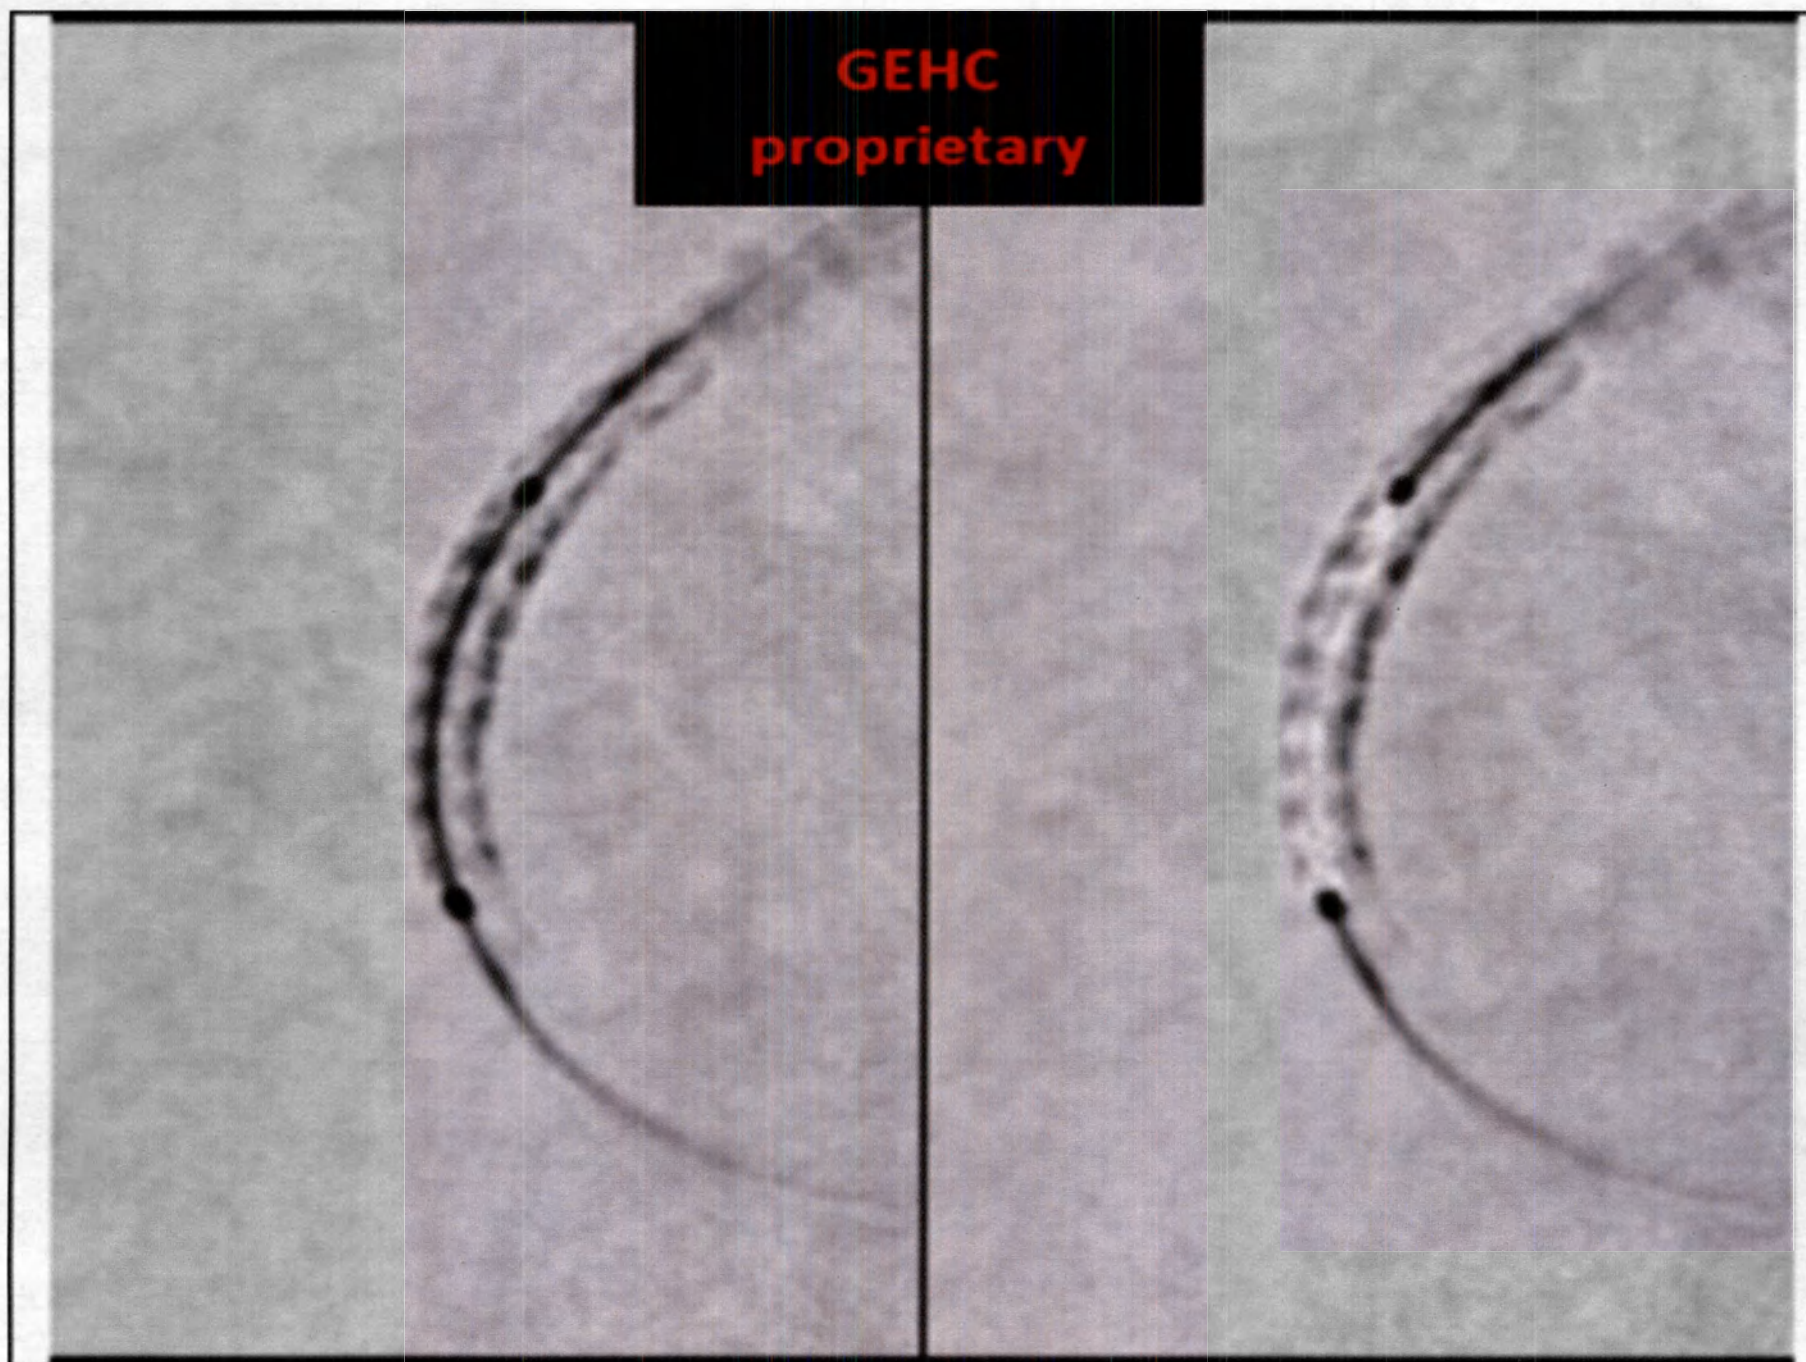


Рисунок 89. Программный модуль улучшенной визуализации стентов коронарных артерий StentViz.



Рисунок 90. Интерфейс управления трехмерными изображениями от стола в процедурной.

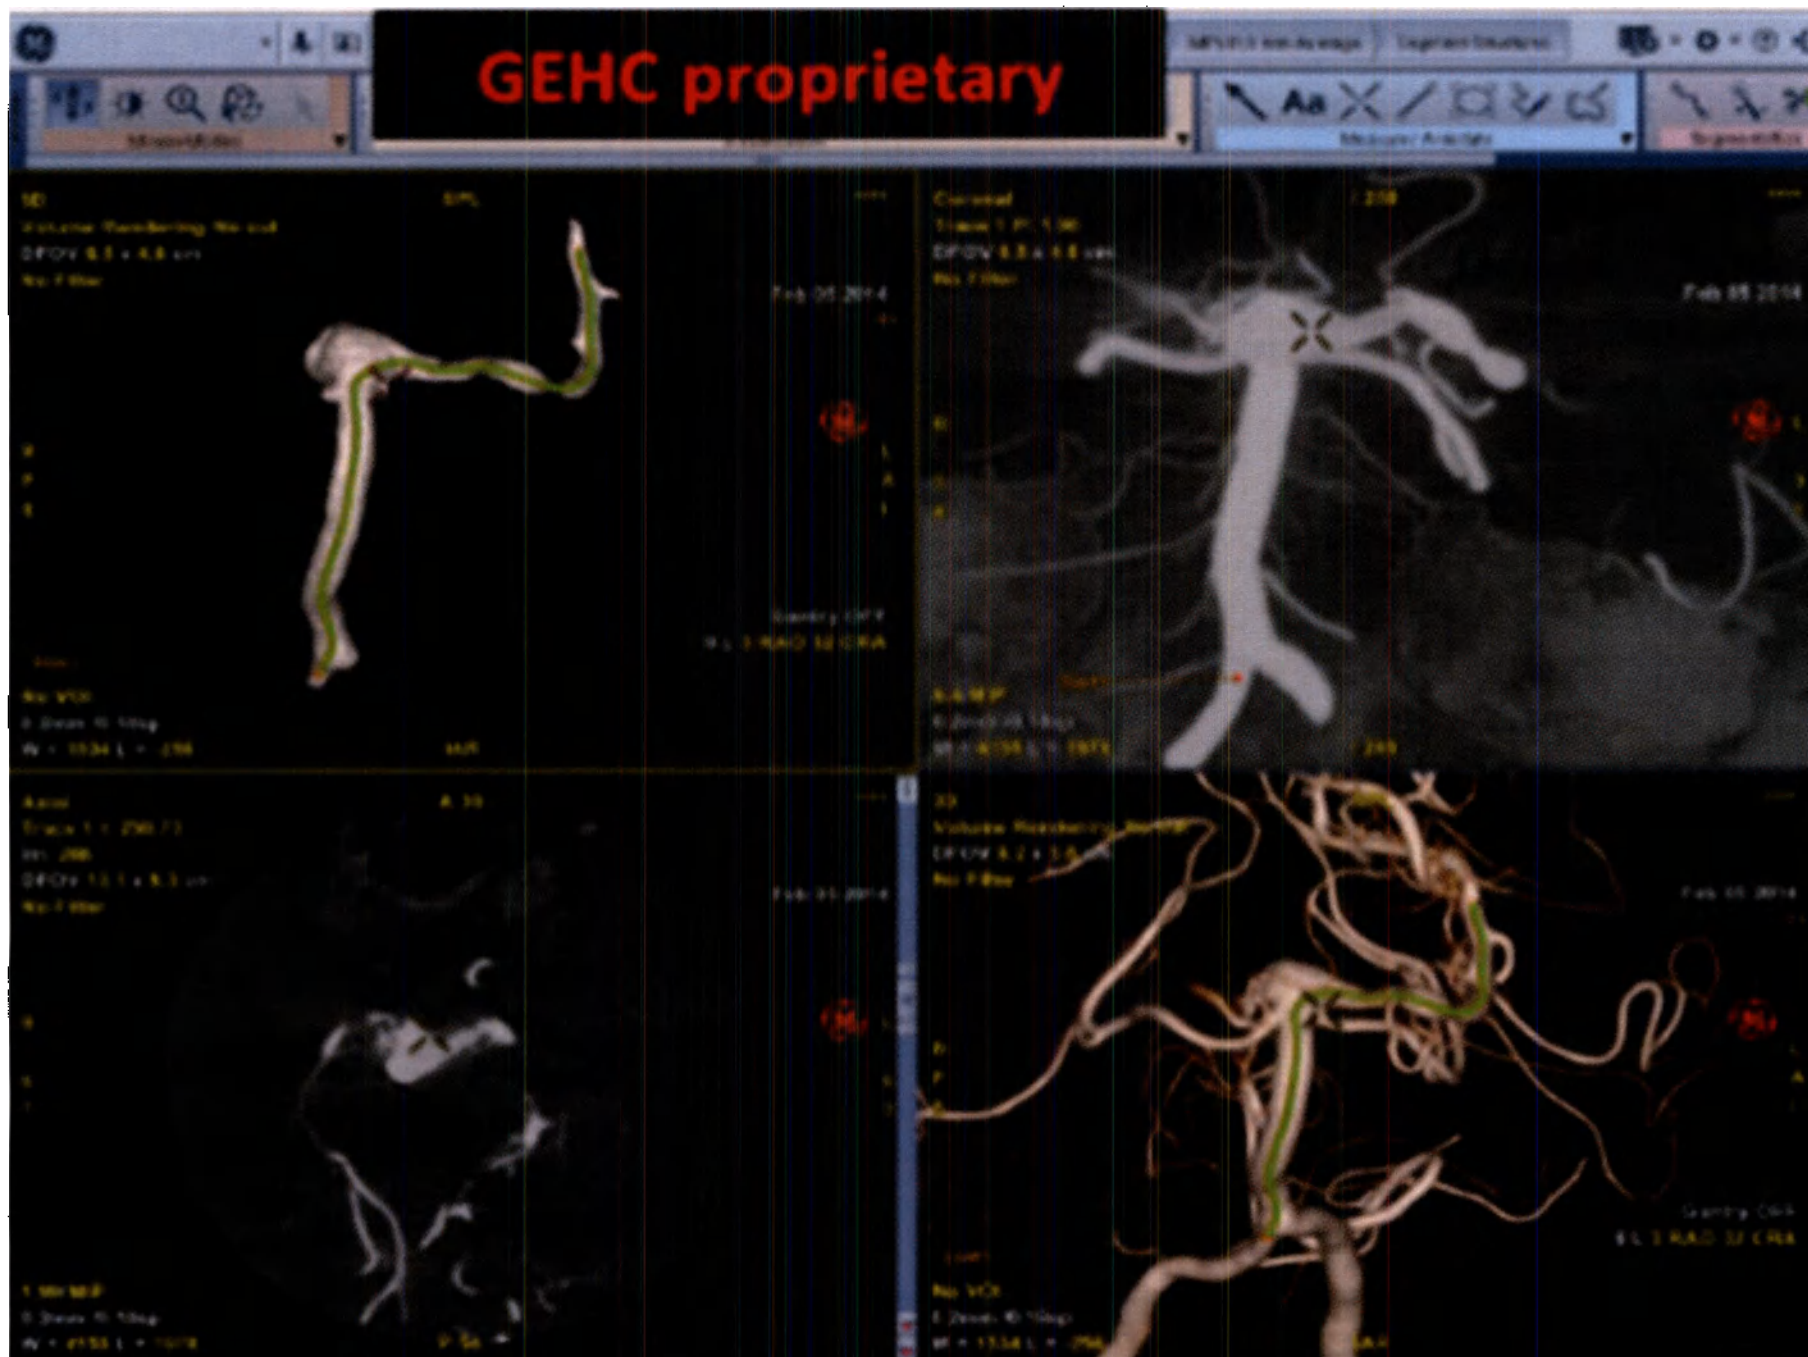


Рисунок 91. Программные модули для экспертного анализа и получения медицинских изображений.

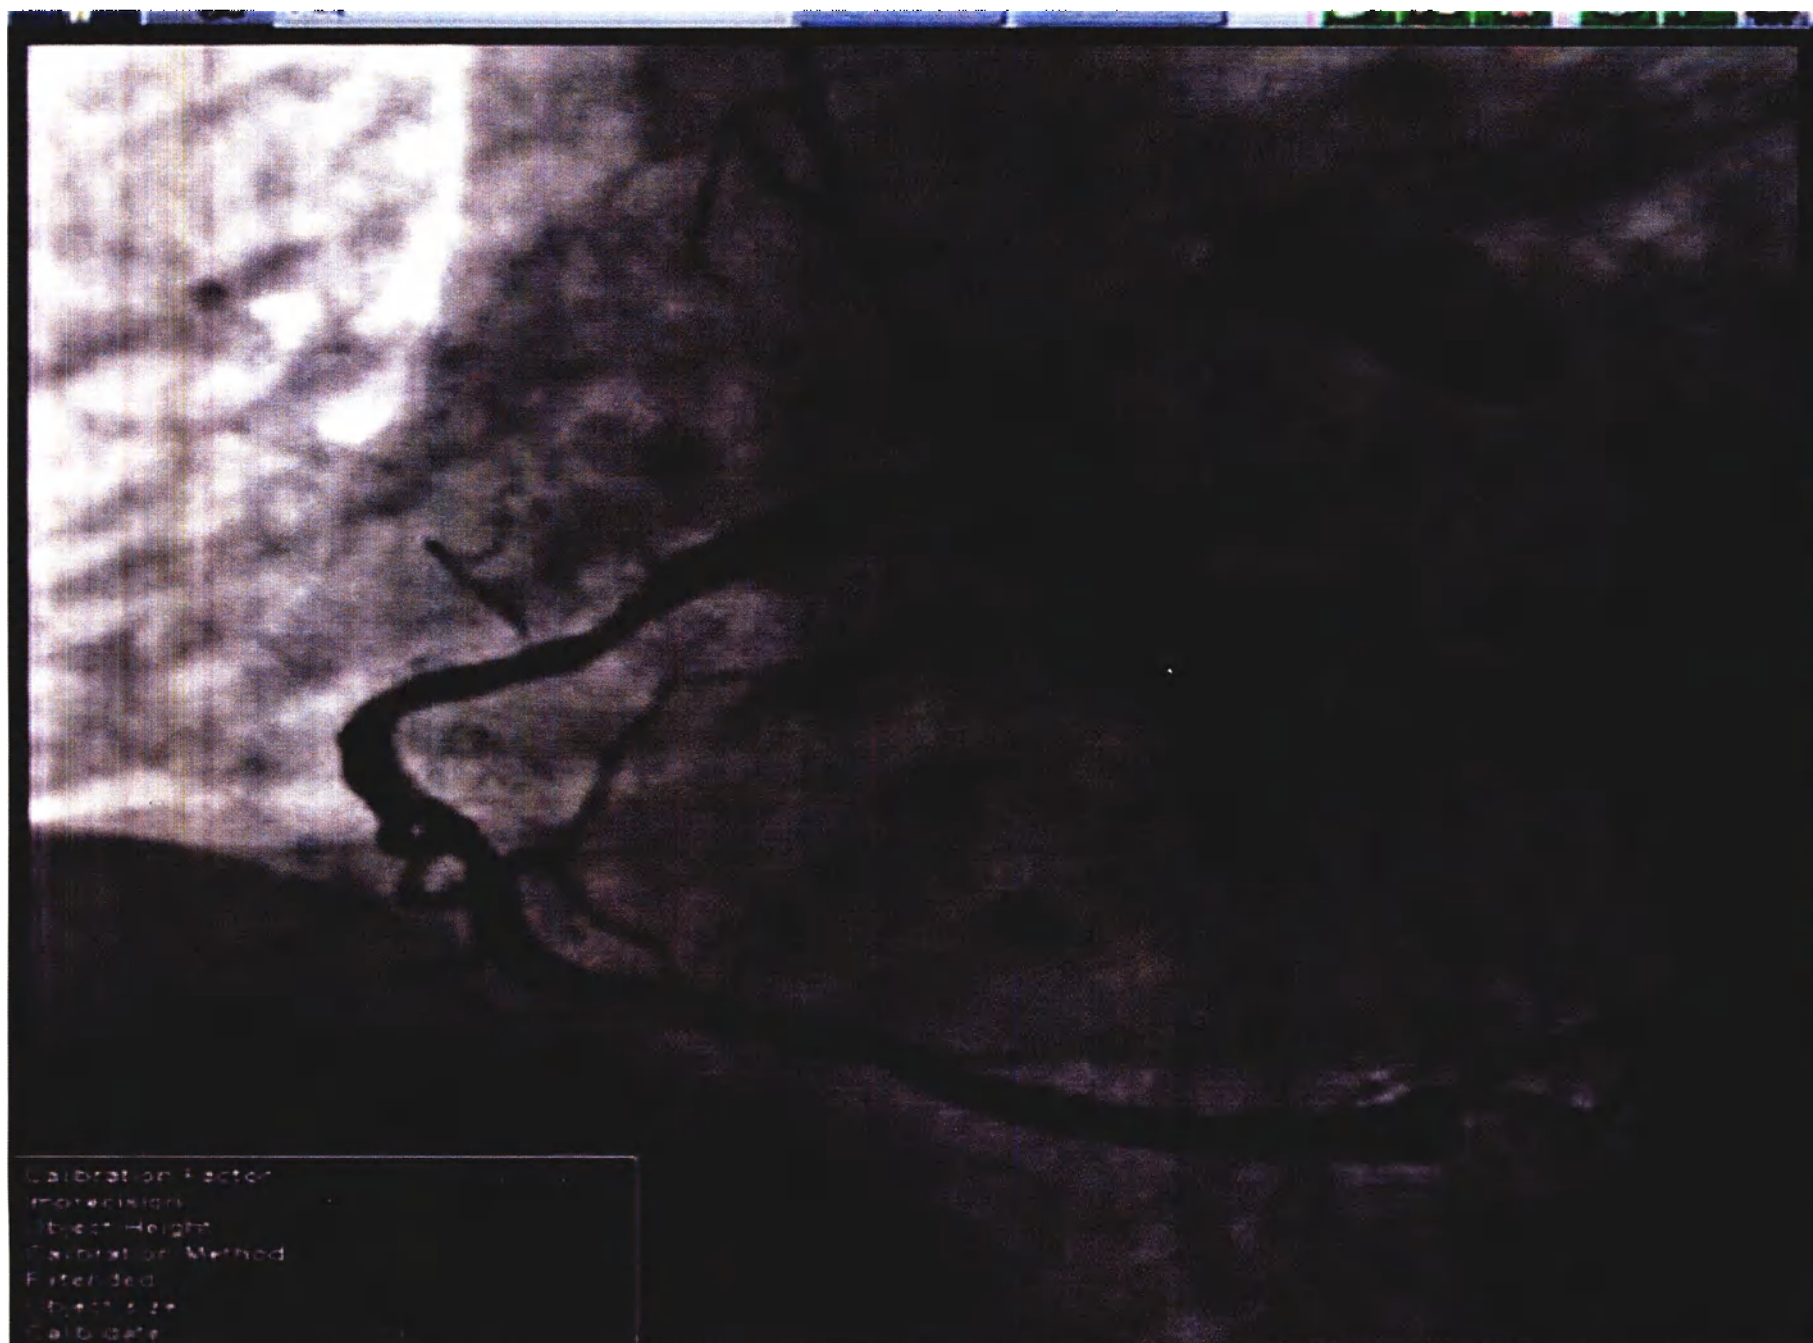


Рисунок 92. Программный модуль количественного кардиологического анализа.

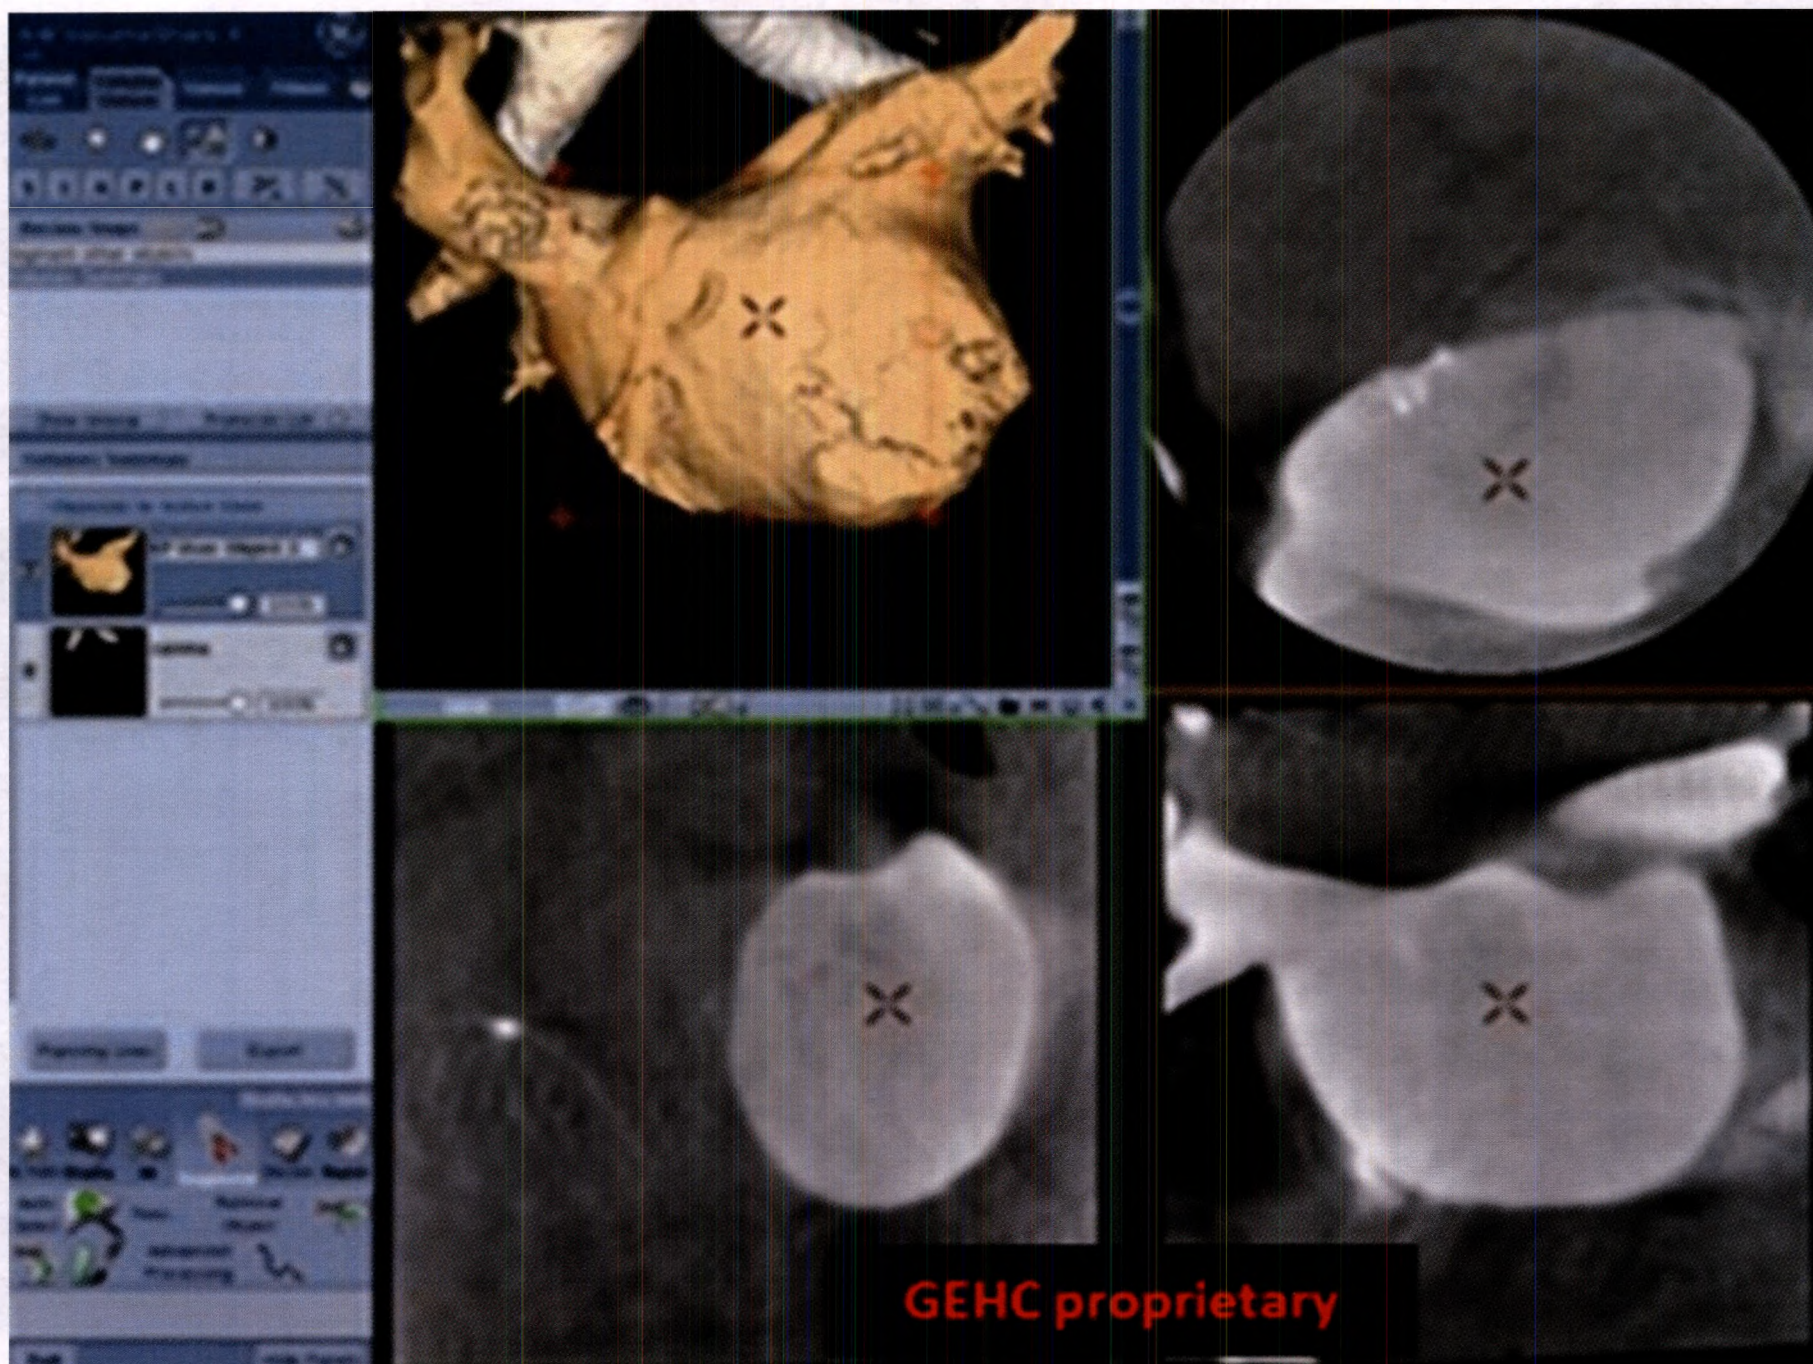


Рисунок 93. Программный модуль трехмерной навигации и построения изображений VALVE ASSIST 2.



Рисунок 94. Программный модуль внутрисосудистой трехмерной навигации VESSEL ASSIST.

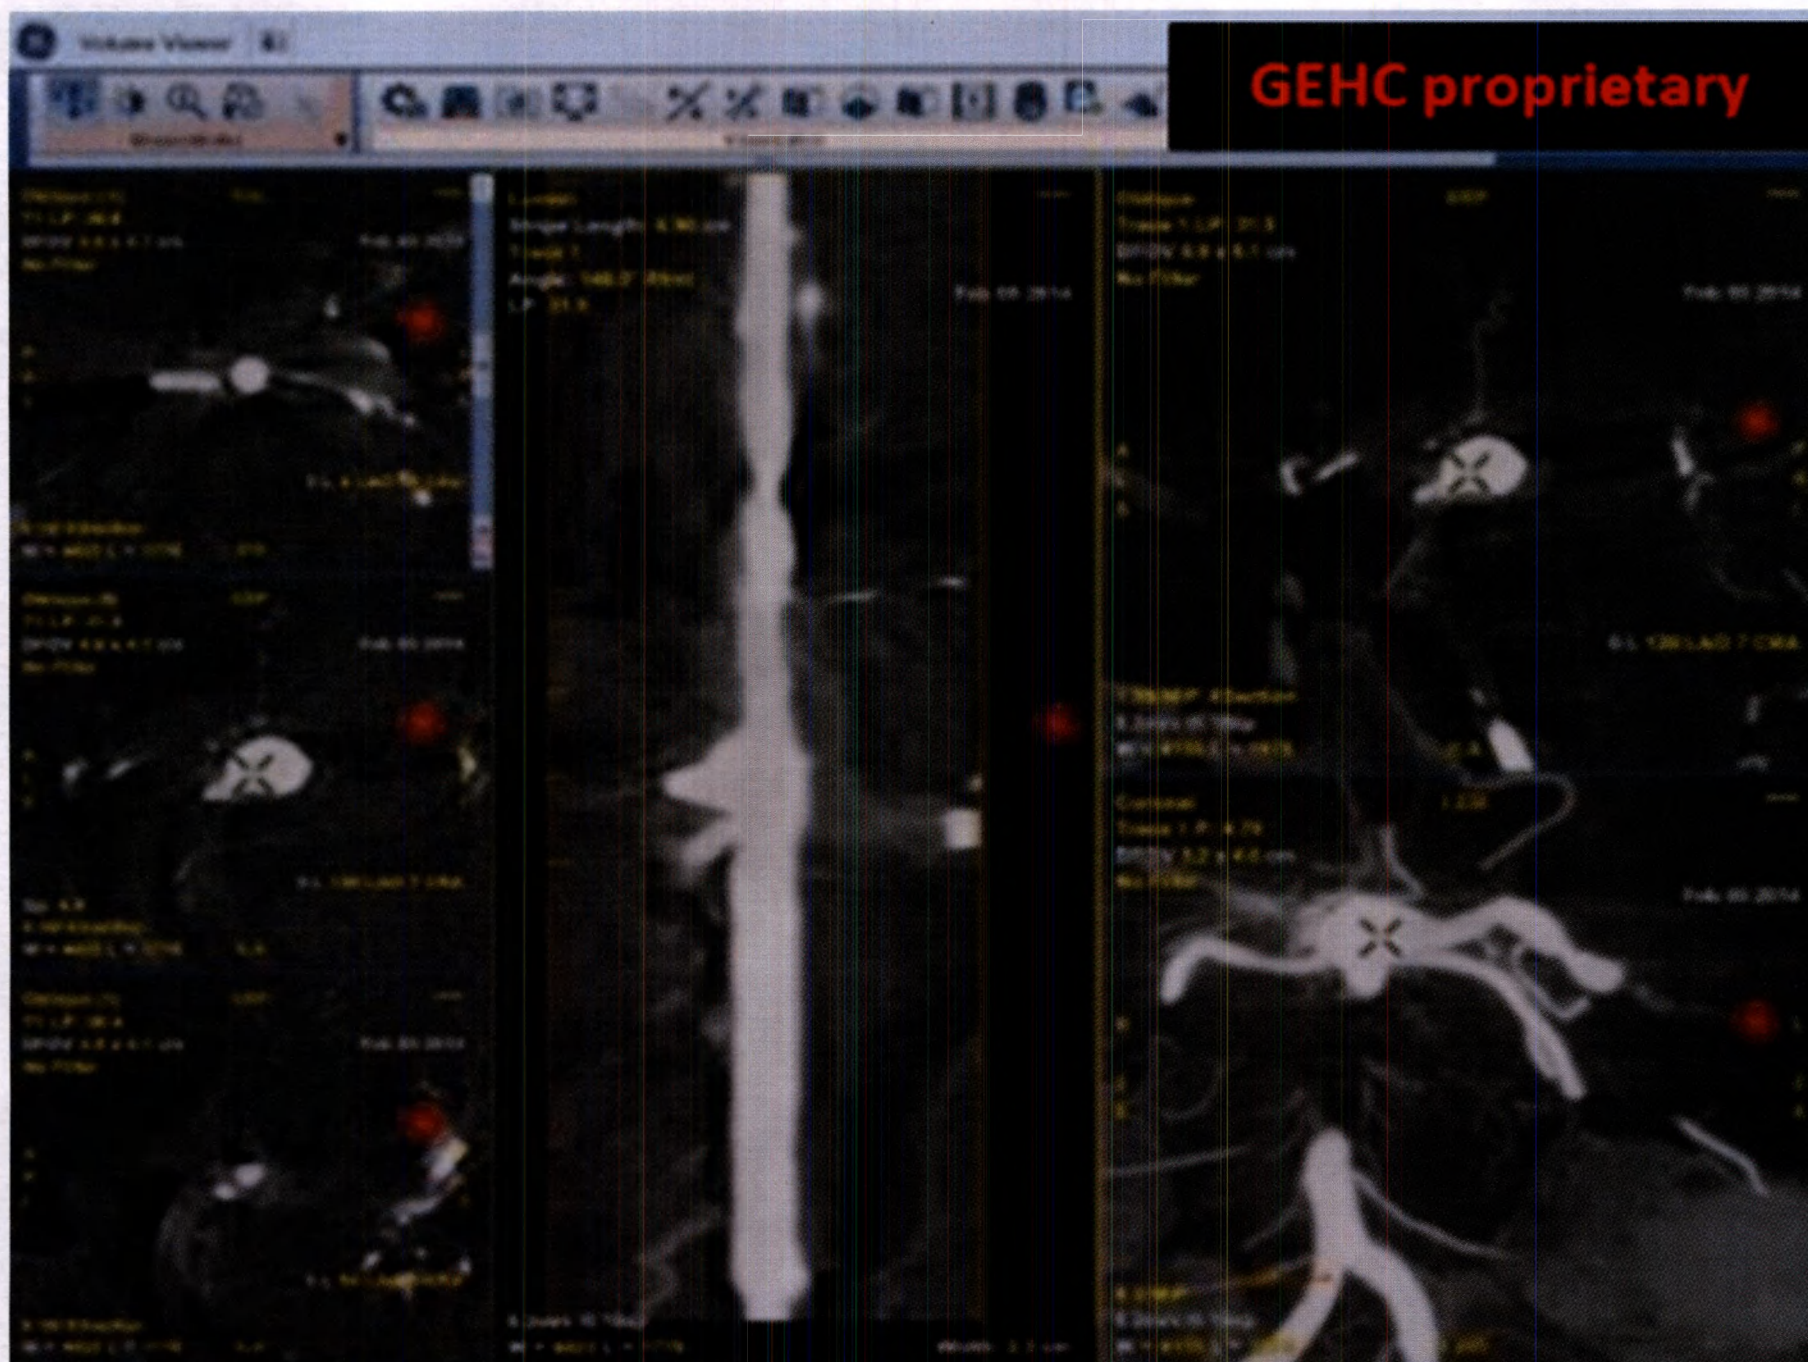


Рисунок 95. Программный модуль внутрисосудистой трехмерной навигации EVAR ASSIST 2.



Рисунок 96. Программные модули пункционной трехмерной навигации Needle ASSIST.



GEHC
proprietary

Рисунок 97. Программные модули трехмерной навигации рабочей станции АW.



Рисунок 98. Модуль расширенной калибровки.

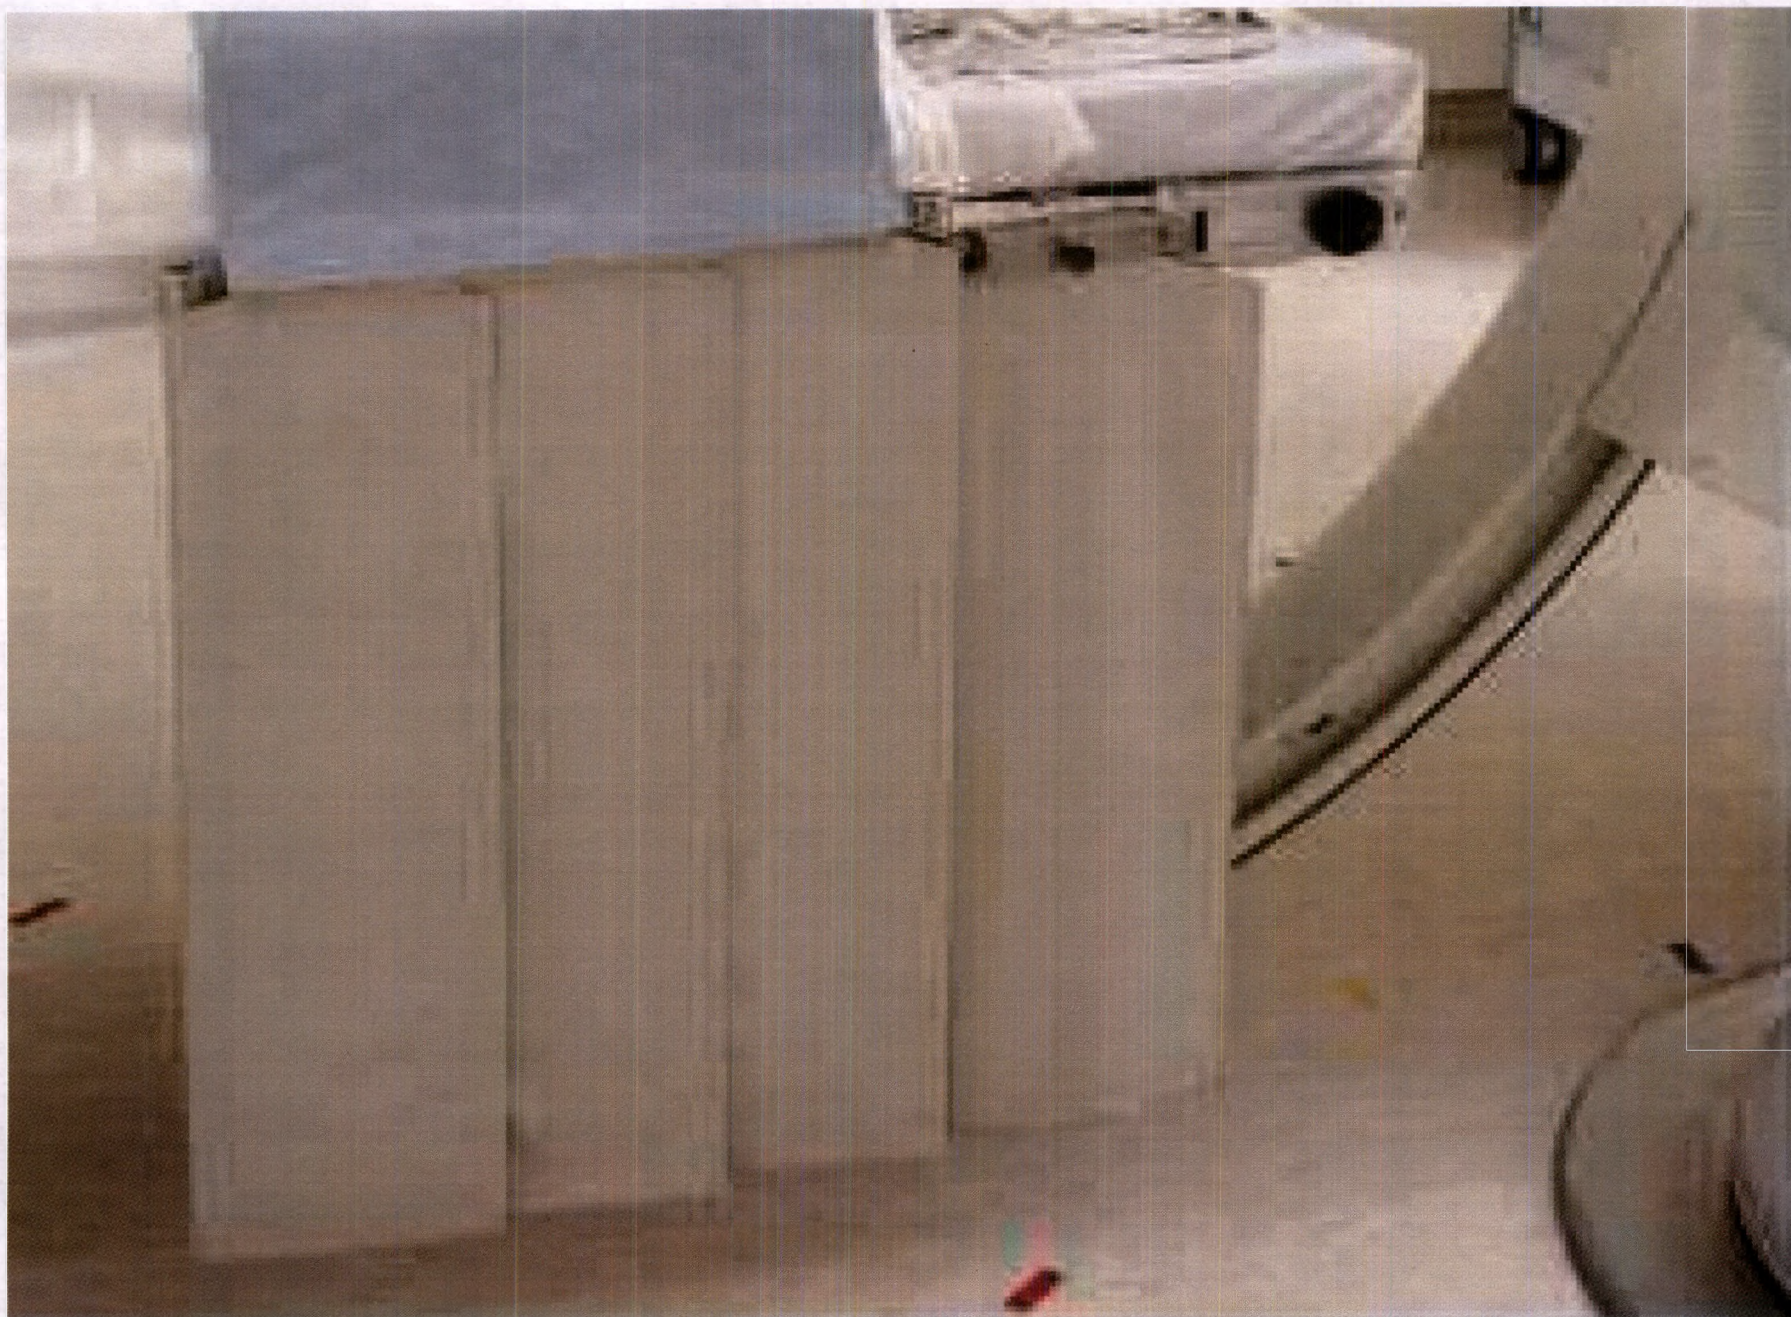


Рисунок 99. Экран для защиты нижней части тела от рентгеновского излучения, монтируемый к столу.

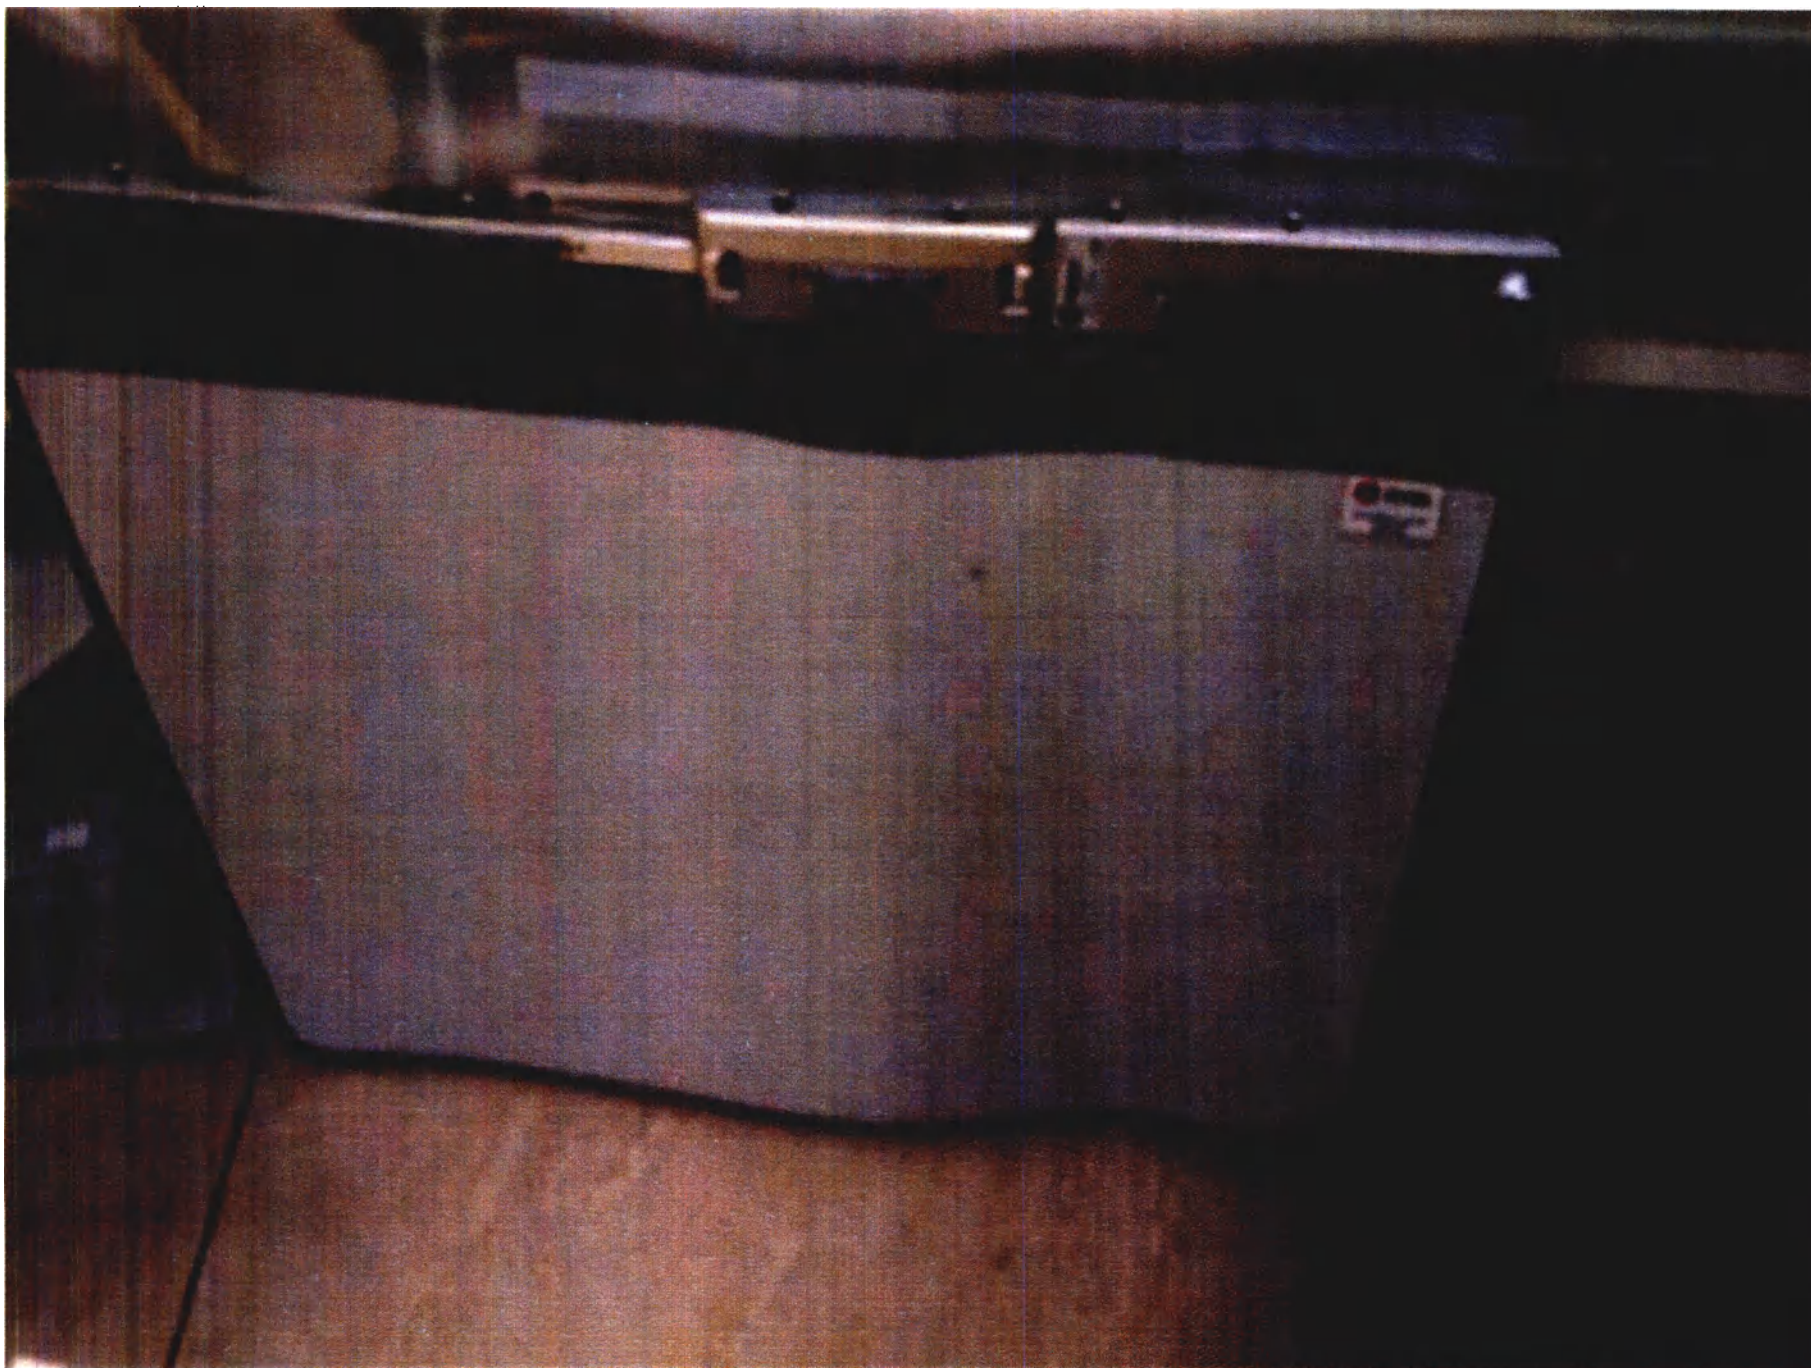


Рисунок 100. Экран для защиты нижней части тела двойной с функцией поворота, монтируемый к столу.

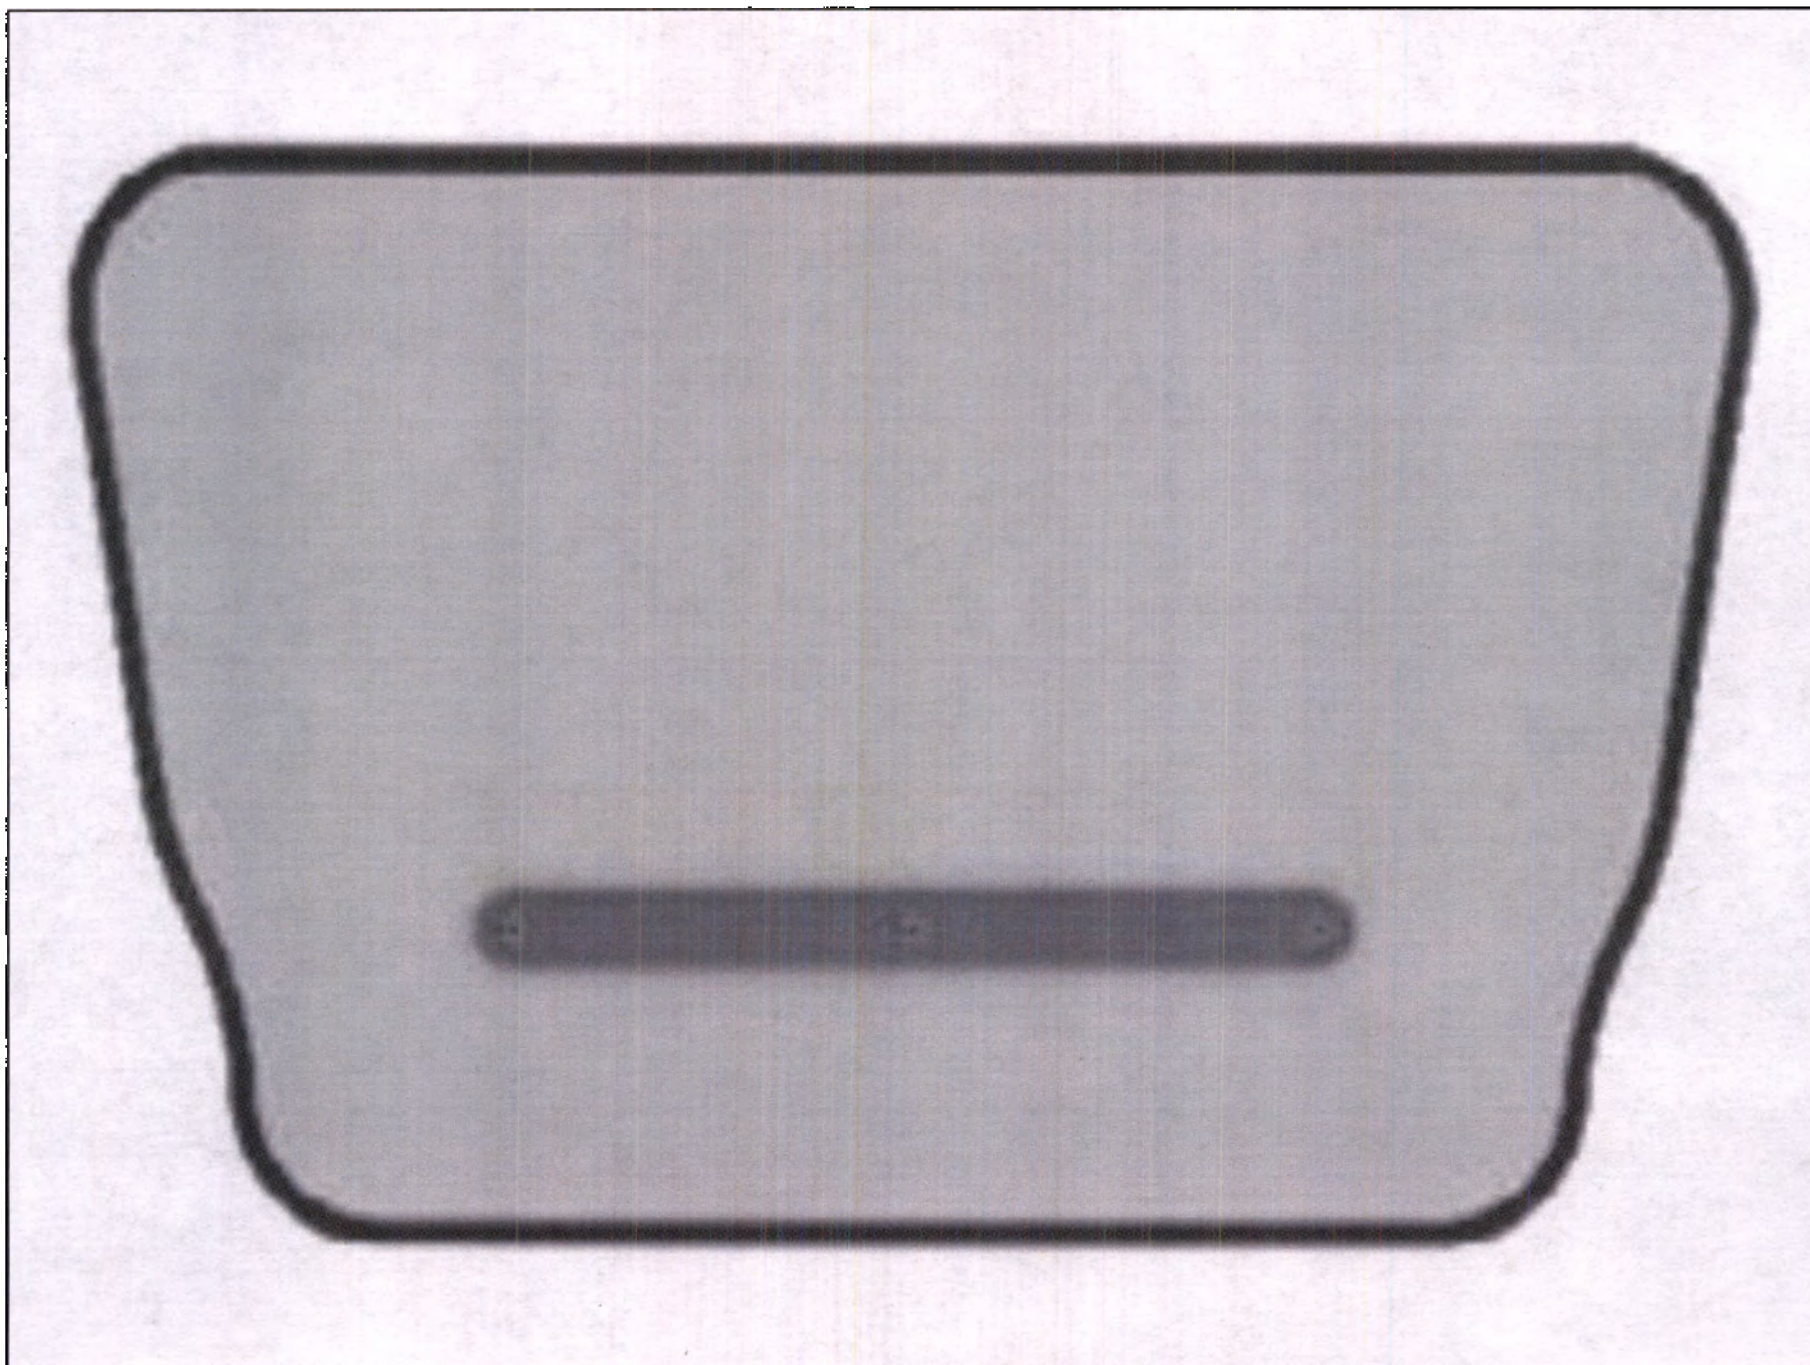


Рисунок 101. Дополнительная часть для расширения в высоту экрана для защиты нижней части тела от рентгеновского излучения, монтируемого к столу.



Рисунок 102. Устройства для монтажа рентгенозащитной ширмы и хирургического светильника потолочного крепления (1- пластина, 2- стойка).

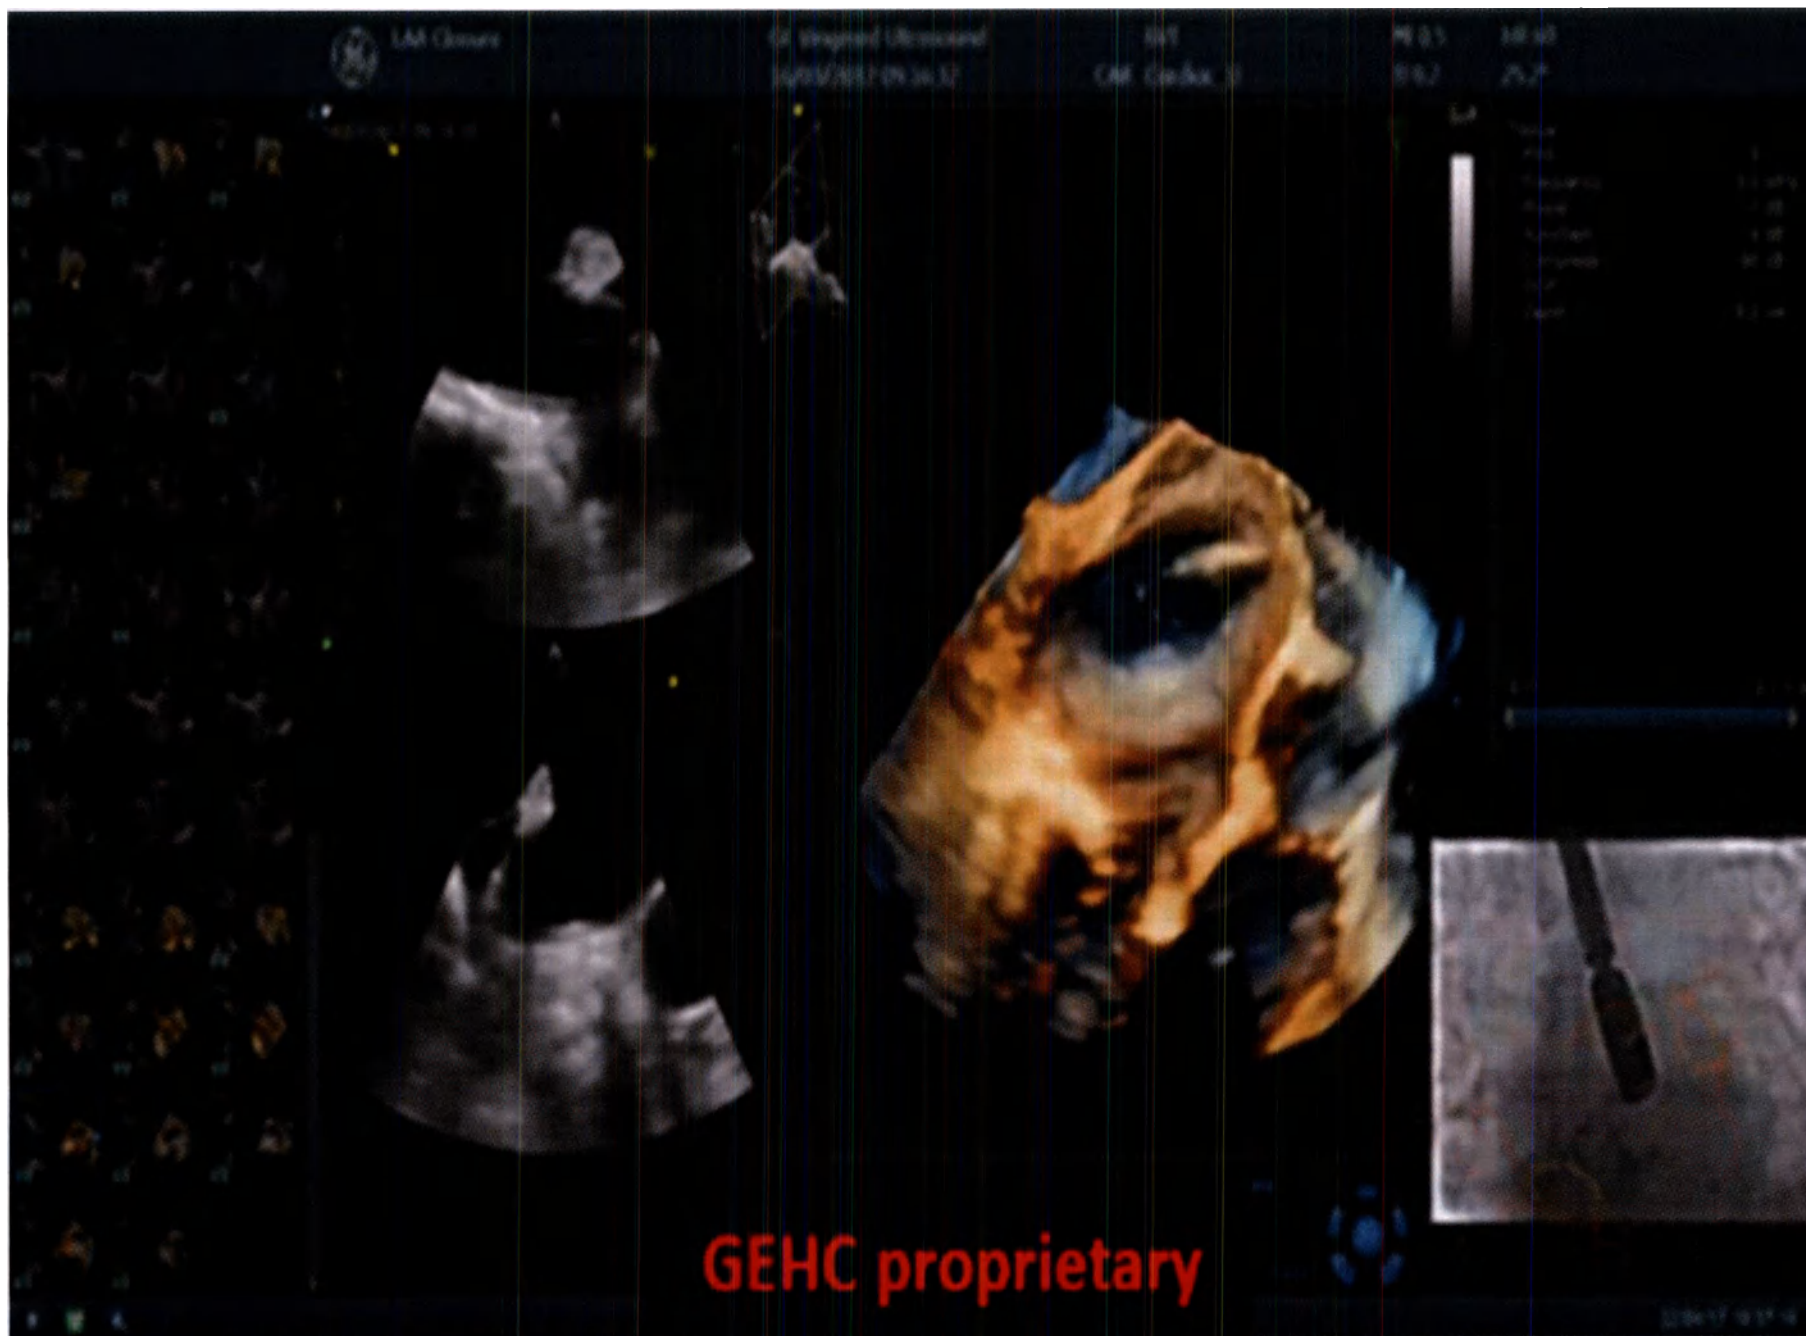


Рисунок 103. Интерфейс для подключения к внешним устройствам.

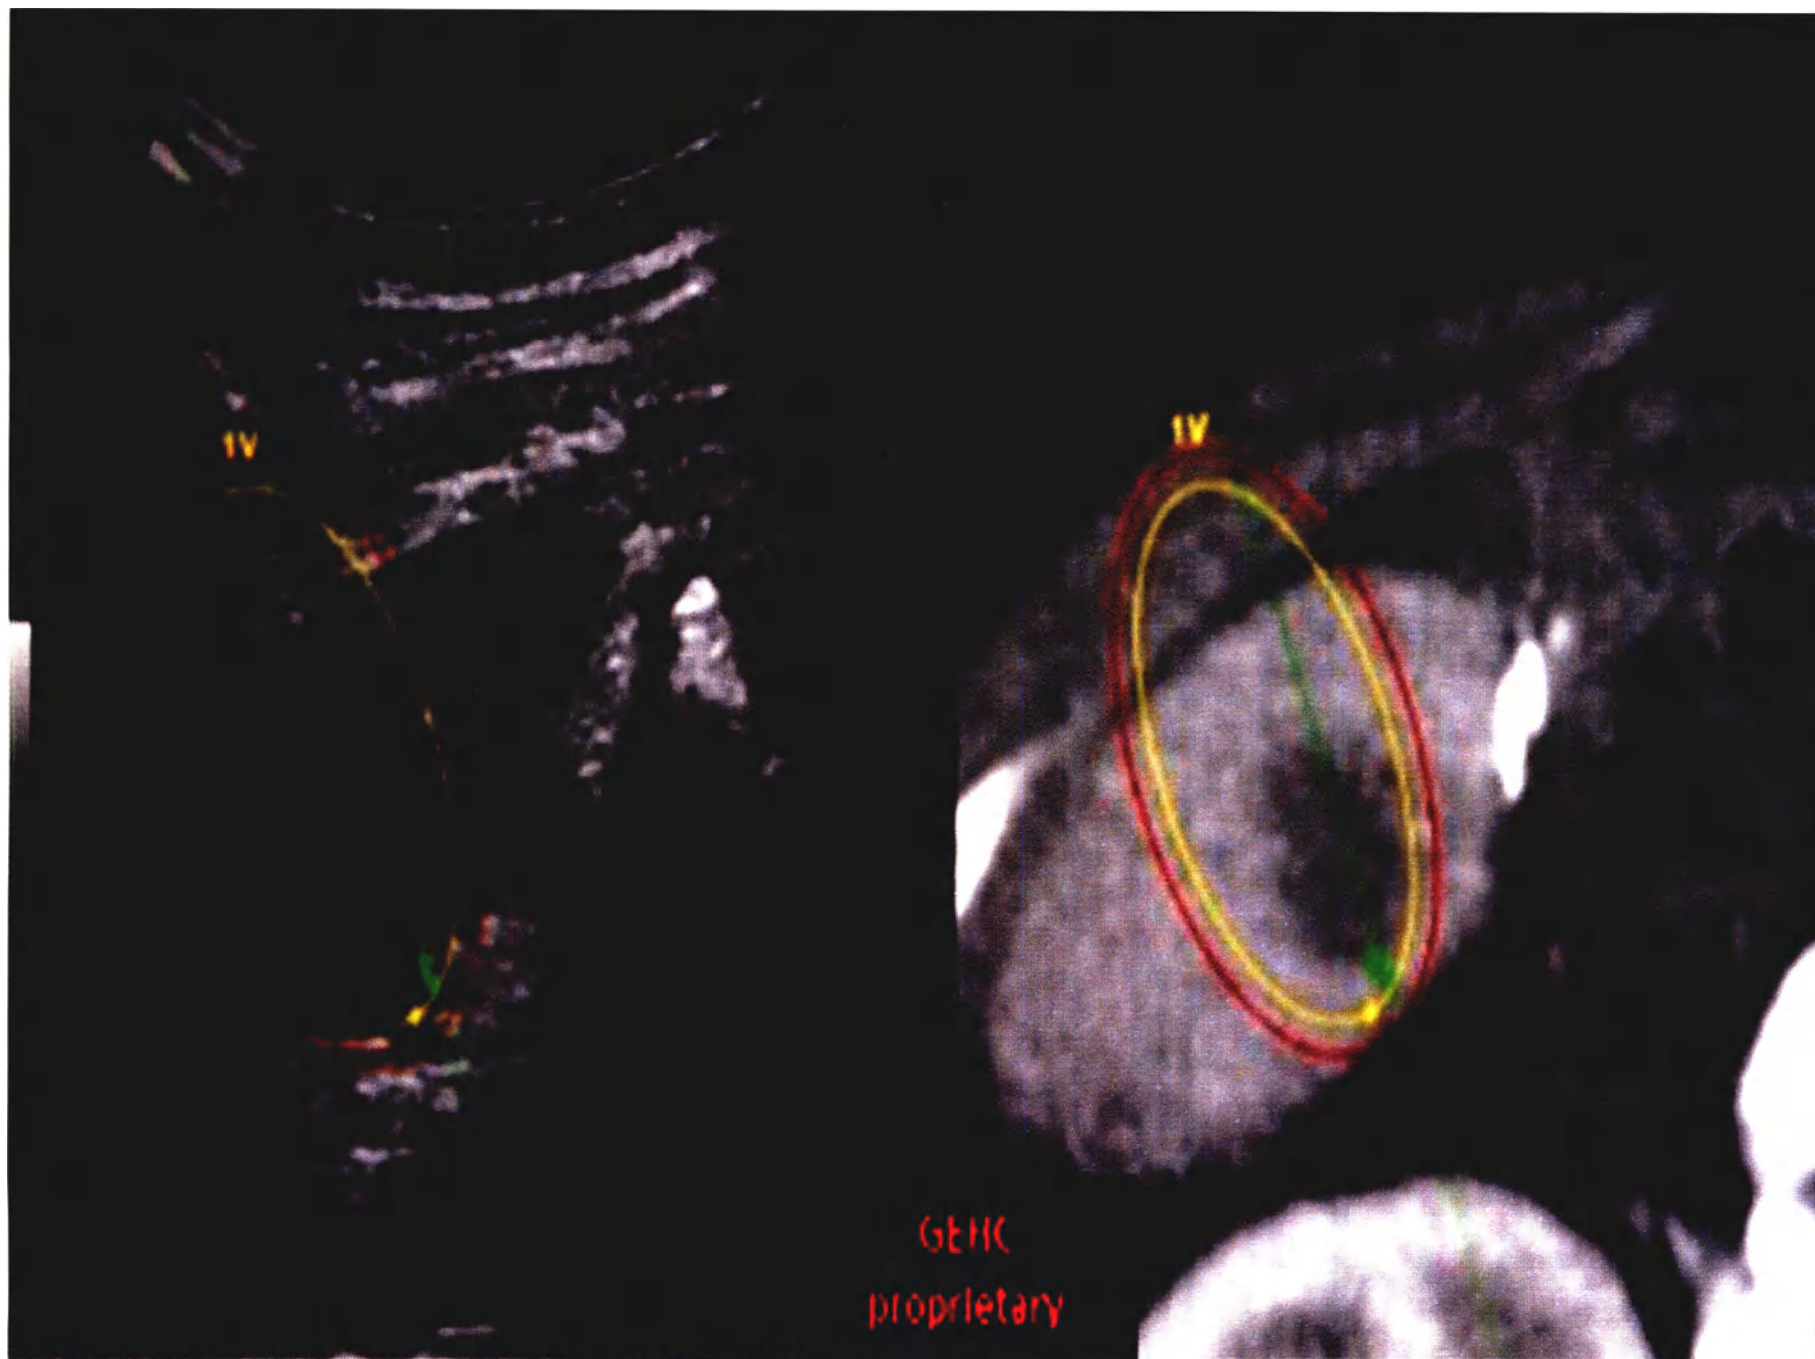


Рисунок 104. Интерфейс для подключения к внешним устройствам.

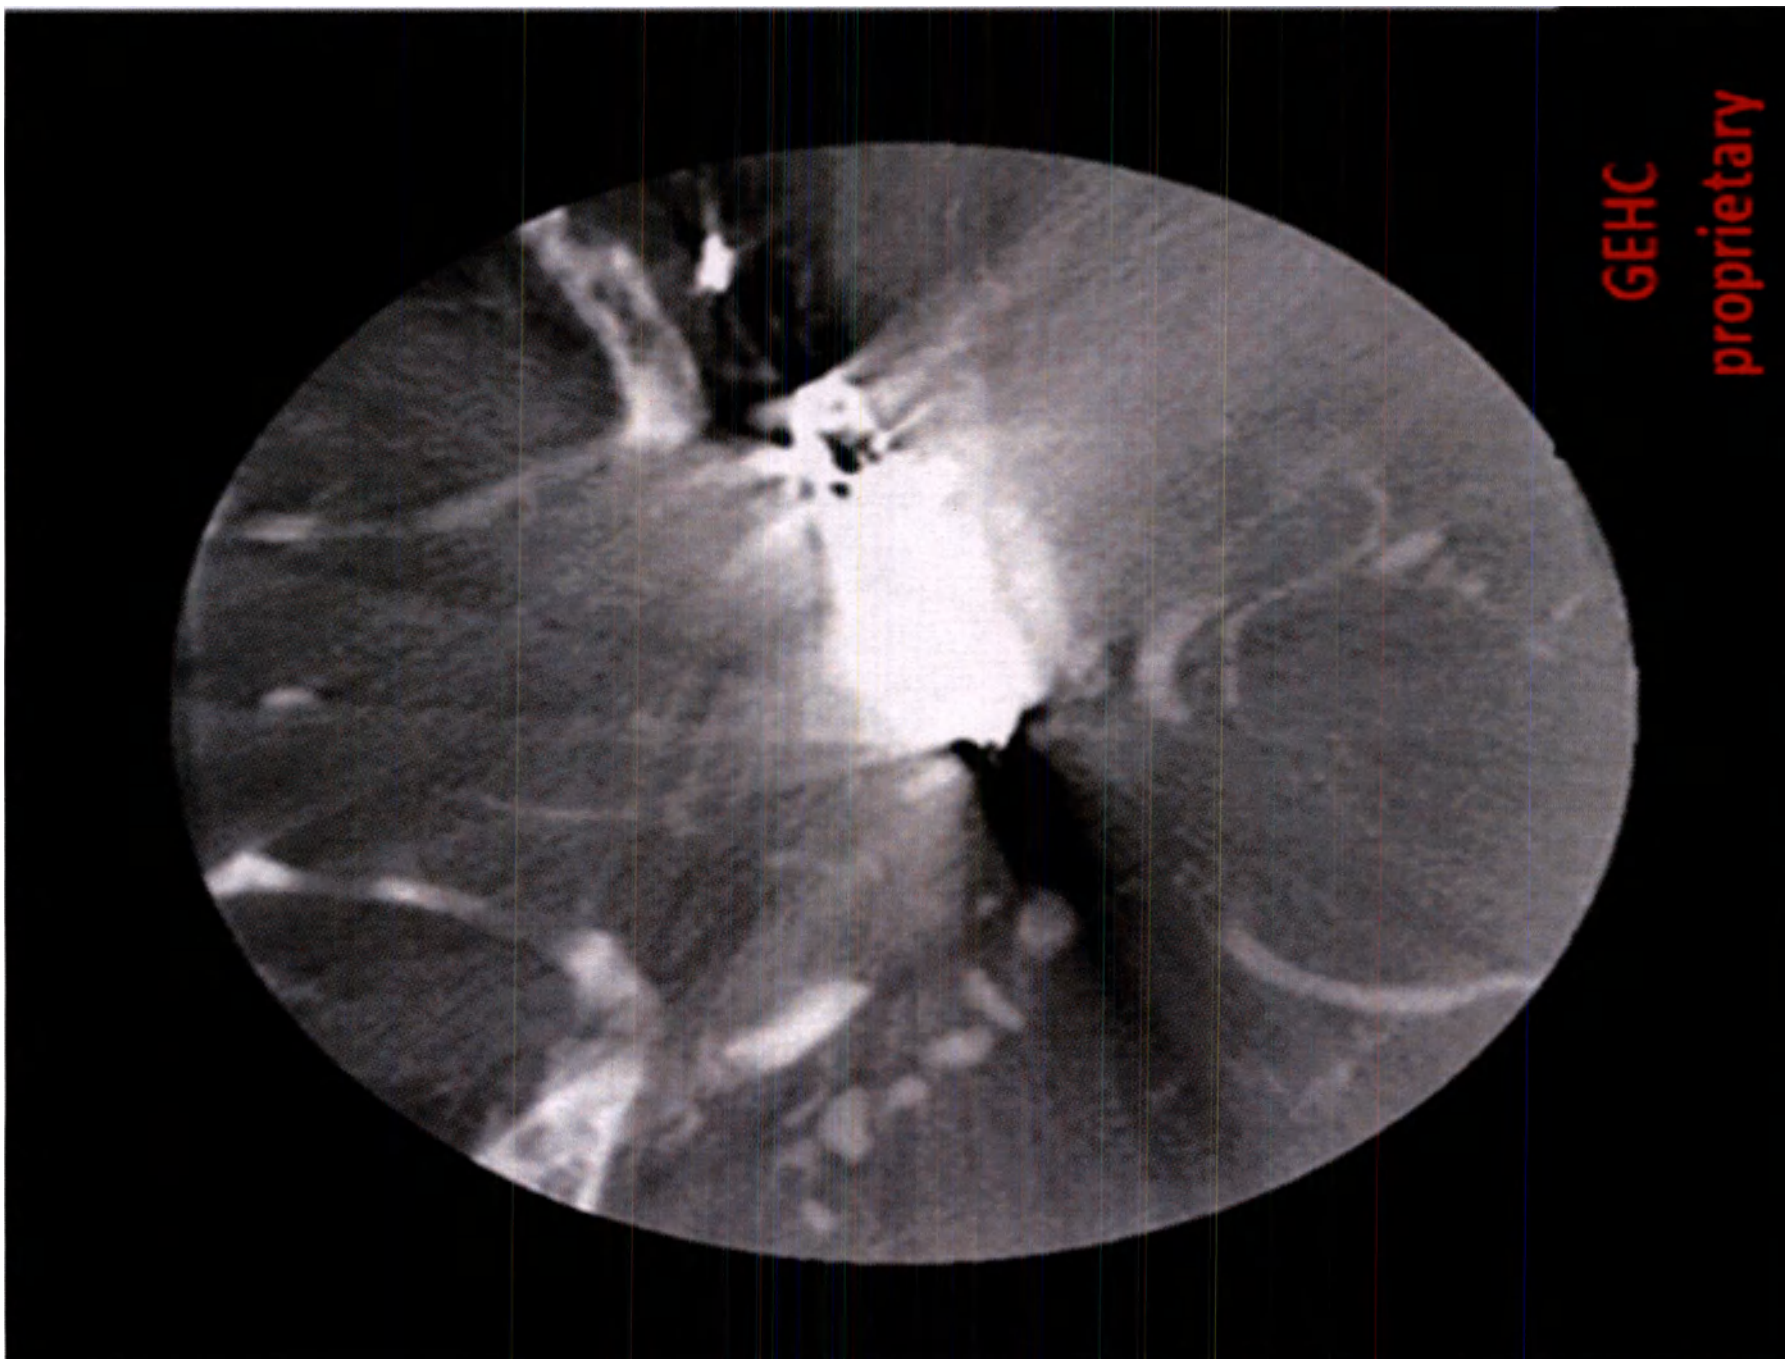


Рисунок 105. Программные приложения для подавления артефактов в объемных изображениях.

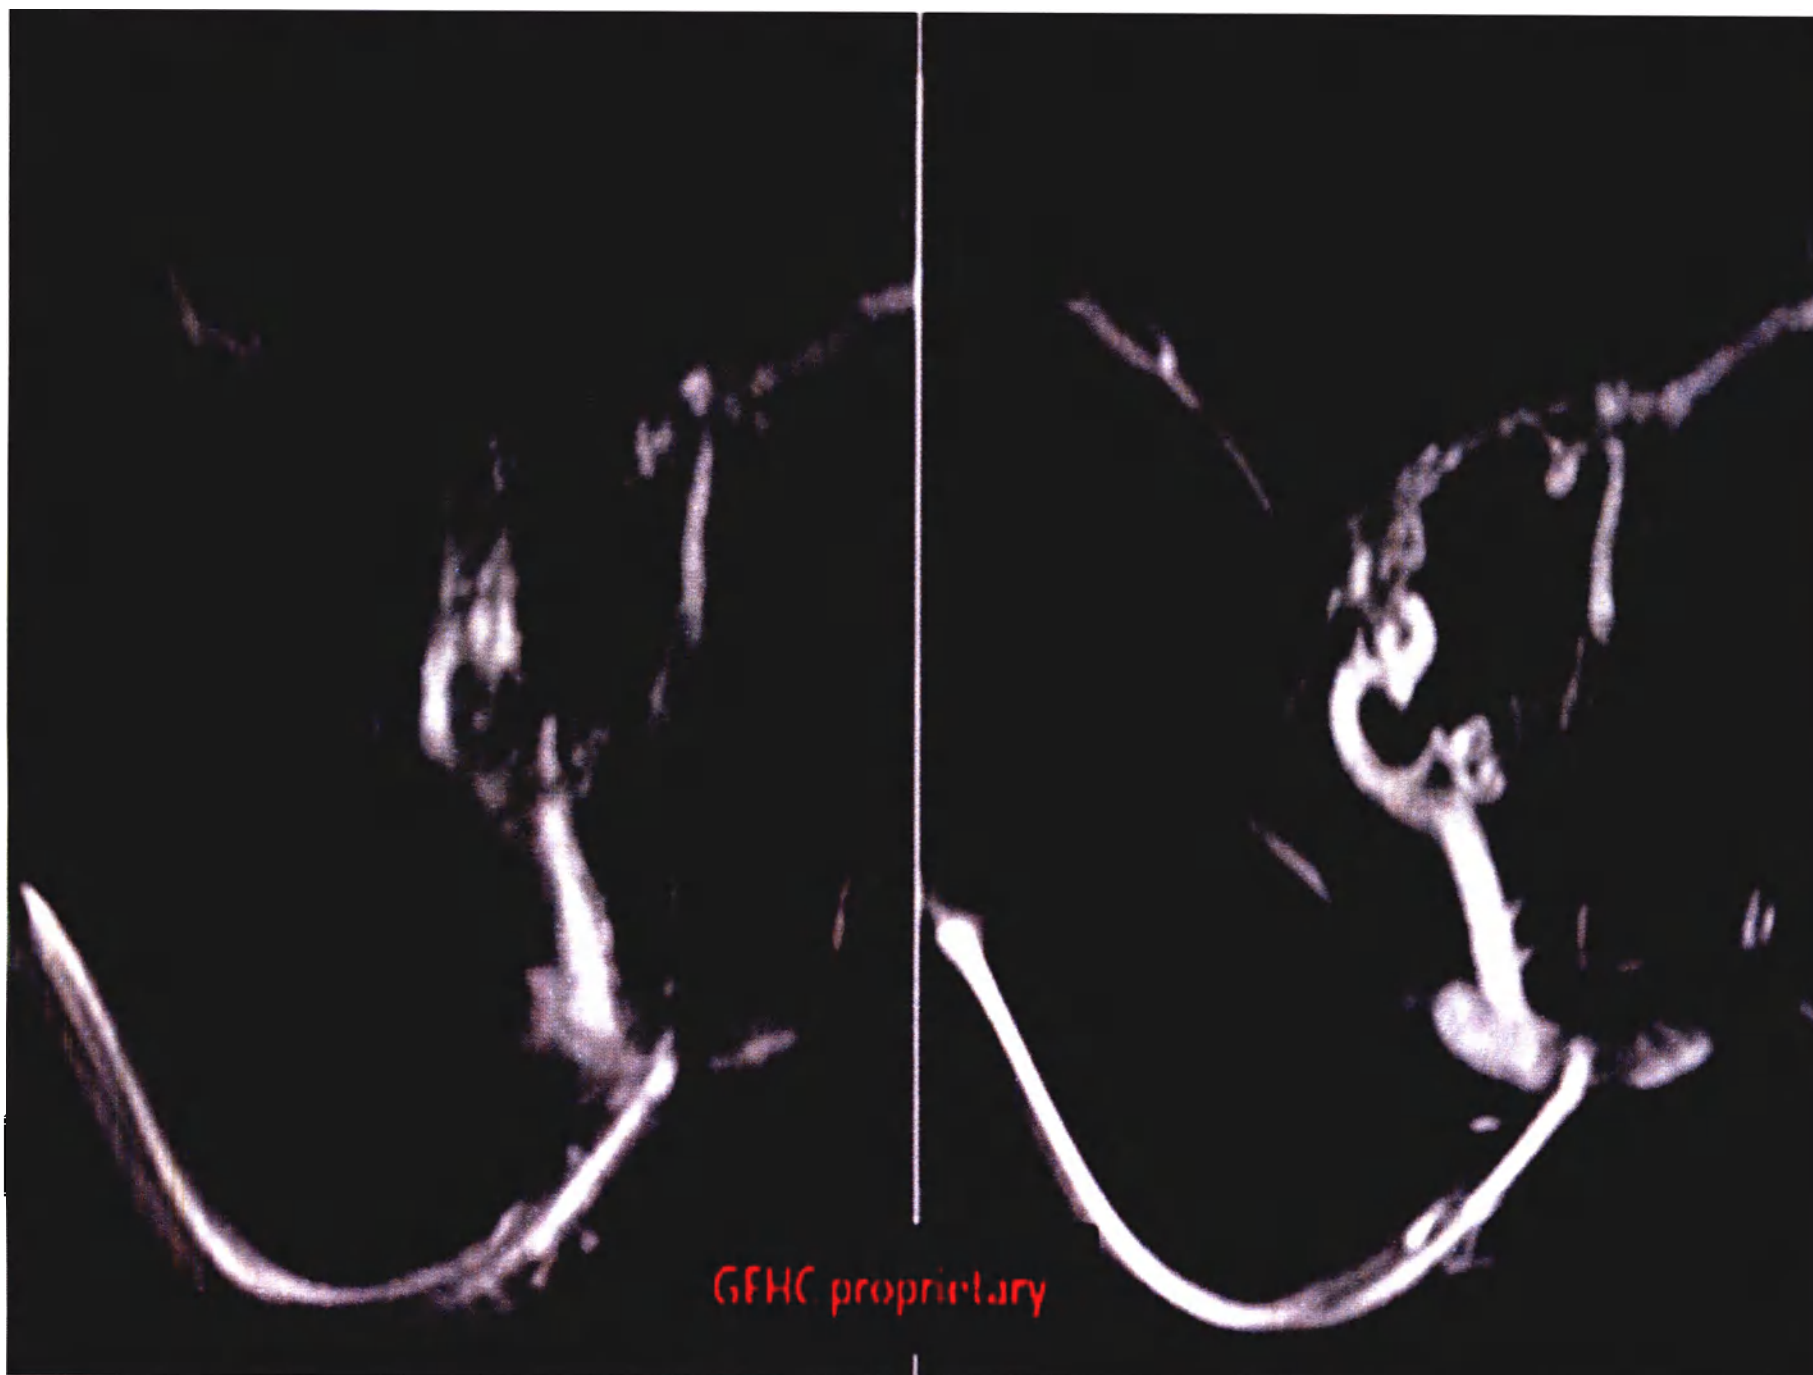


Рисунок 106. Программные приложения для подавления артефактов в объемных изображениях.

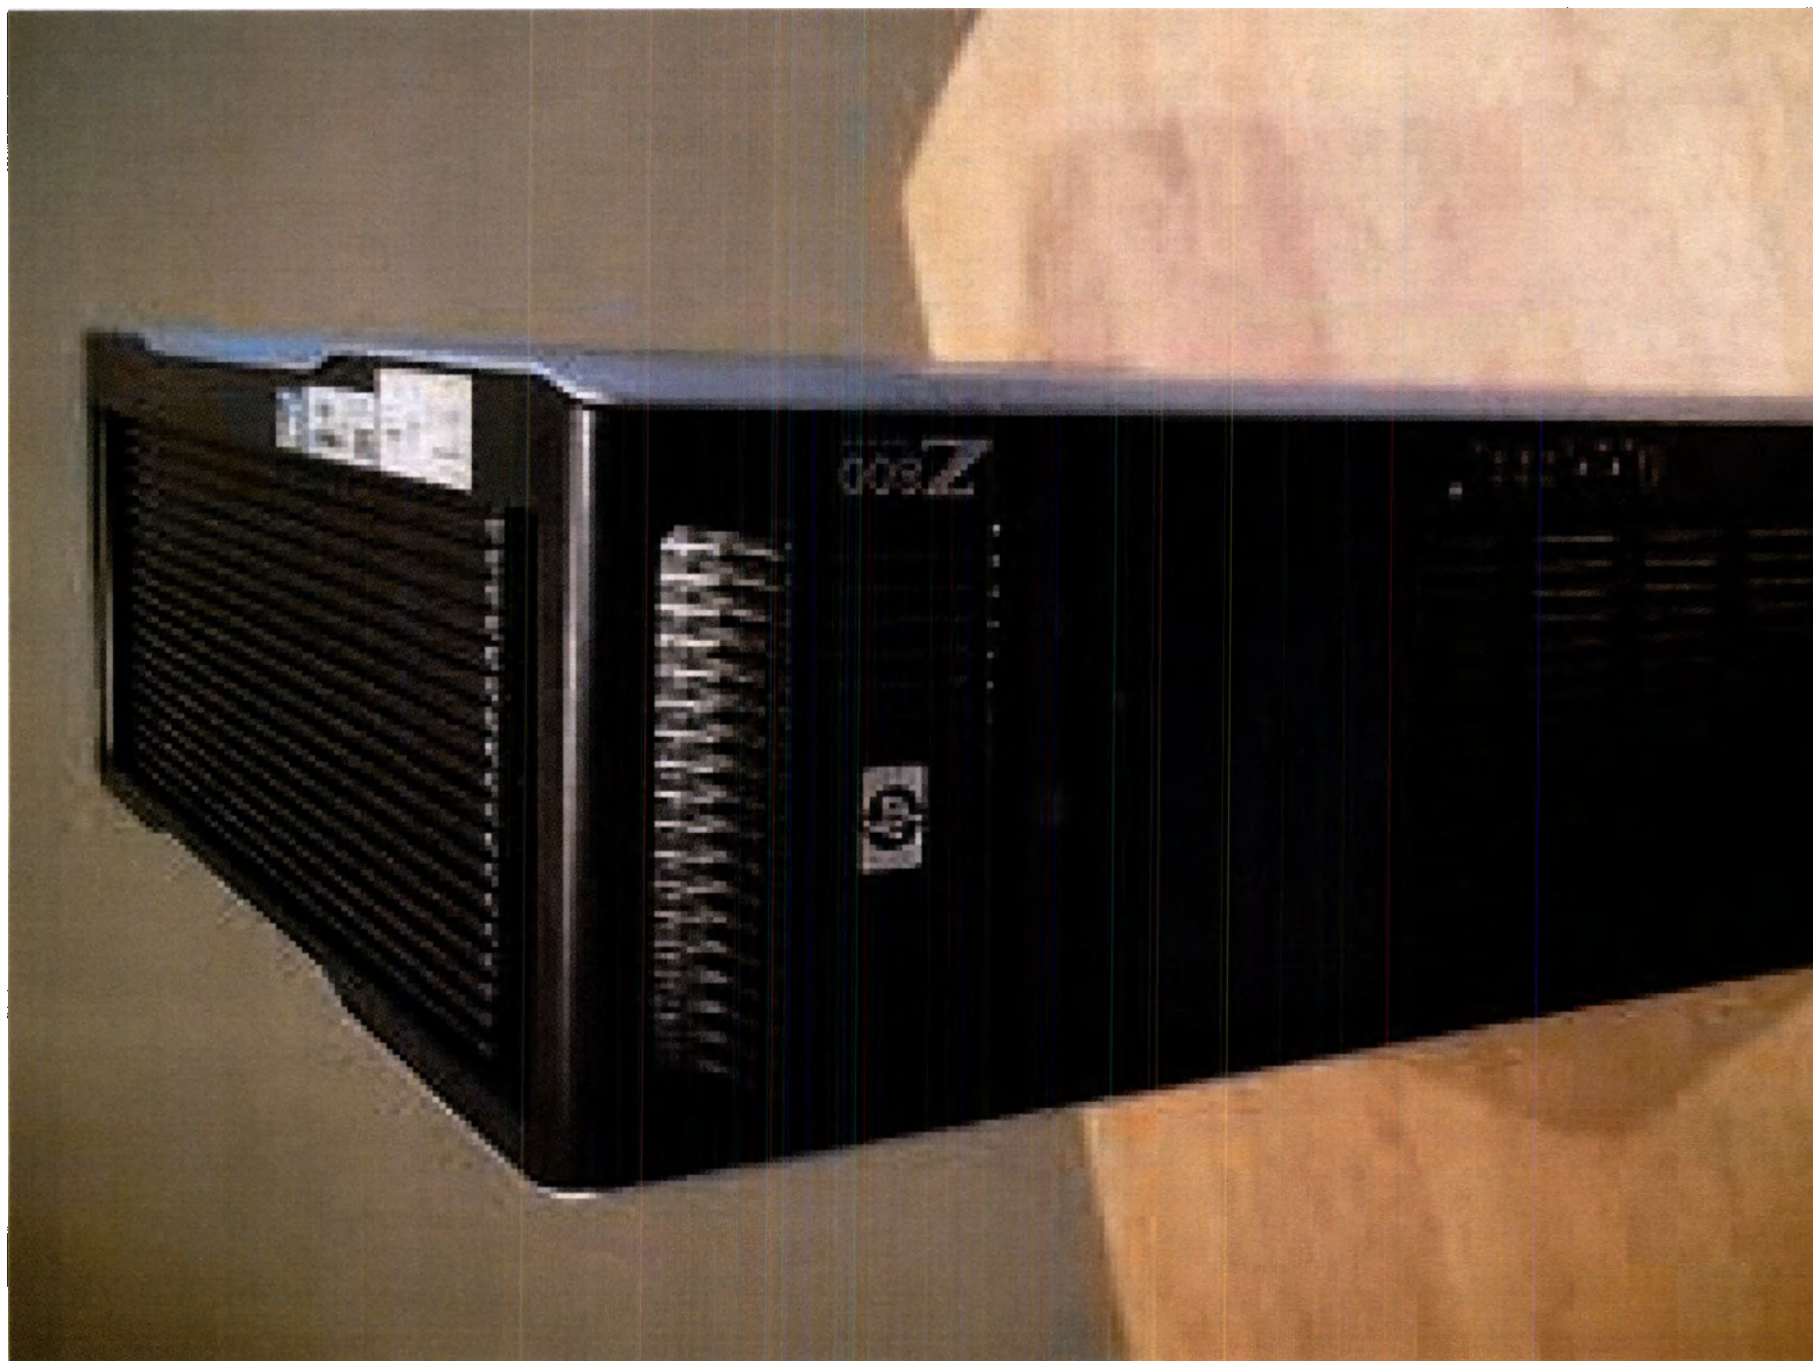


Рисунок 107. Рабочие станции для просмотра, обработки и архивации медицинских изображений.

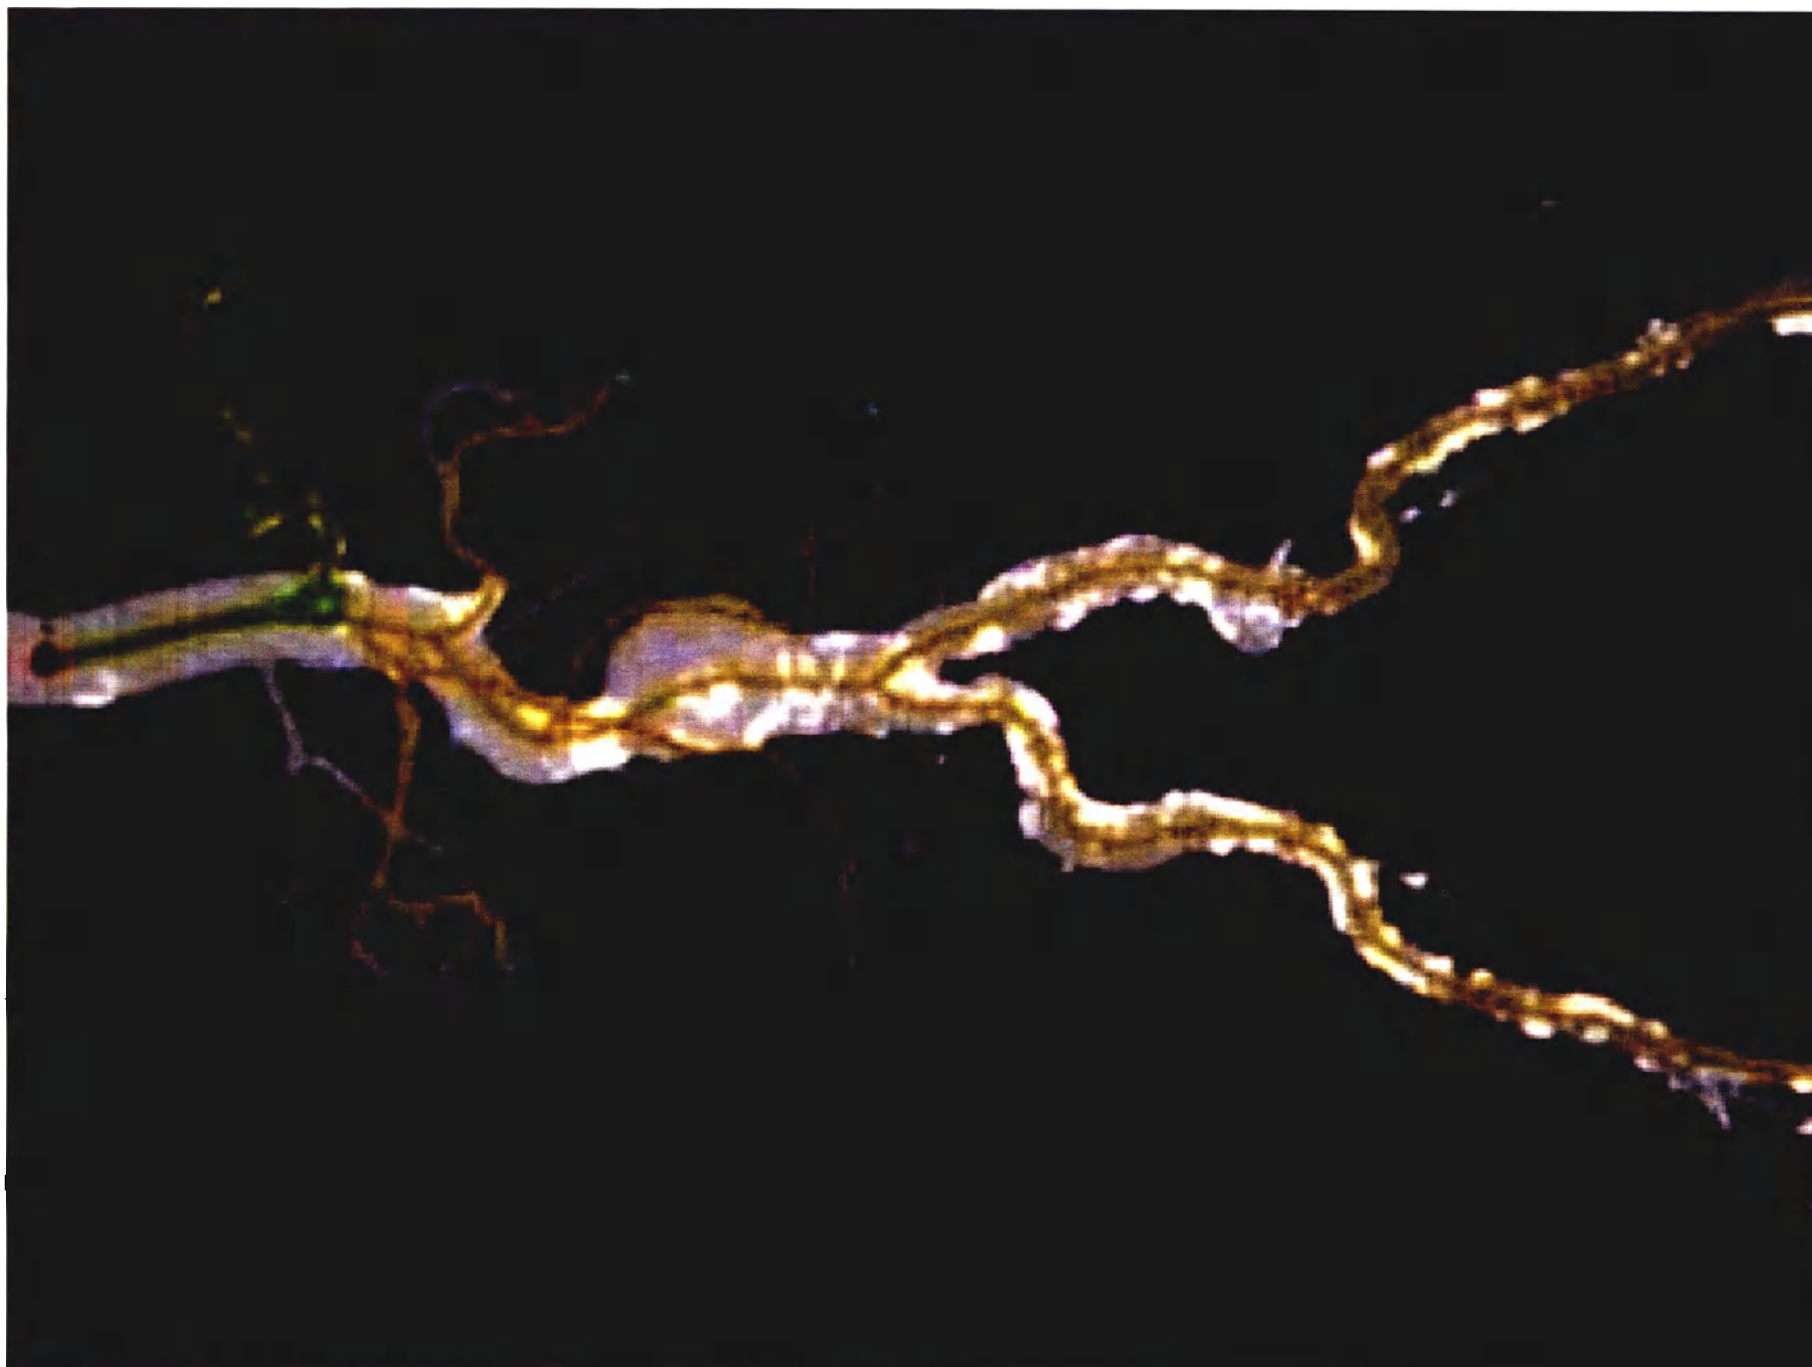


Рисунок 108. Программные модули для рабочей станции.



Рисунок 109. Рабочая станция сбора медицинских данных.



Рисунок 110. Модуль сбора медицинских данных.



Рисунок 111. Модуль сбора медицинских данных (часть модуля, находящаяся в пультовой).

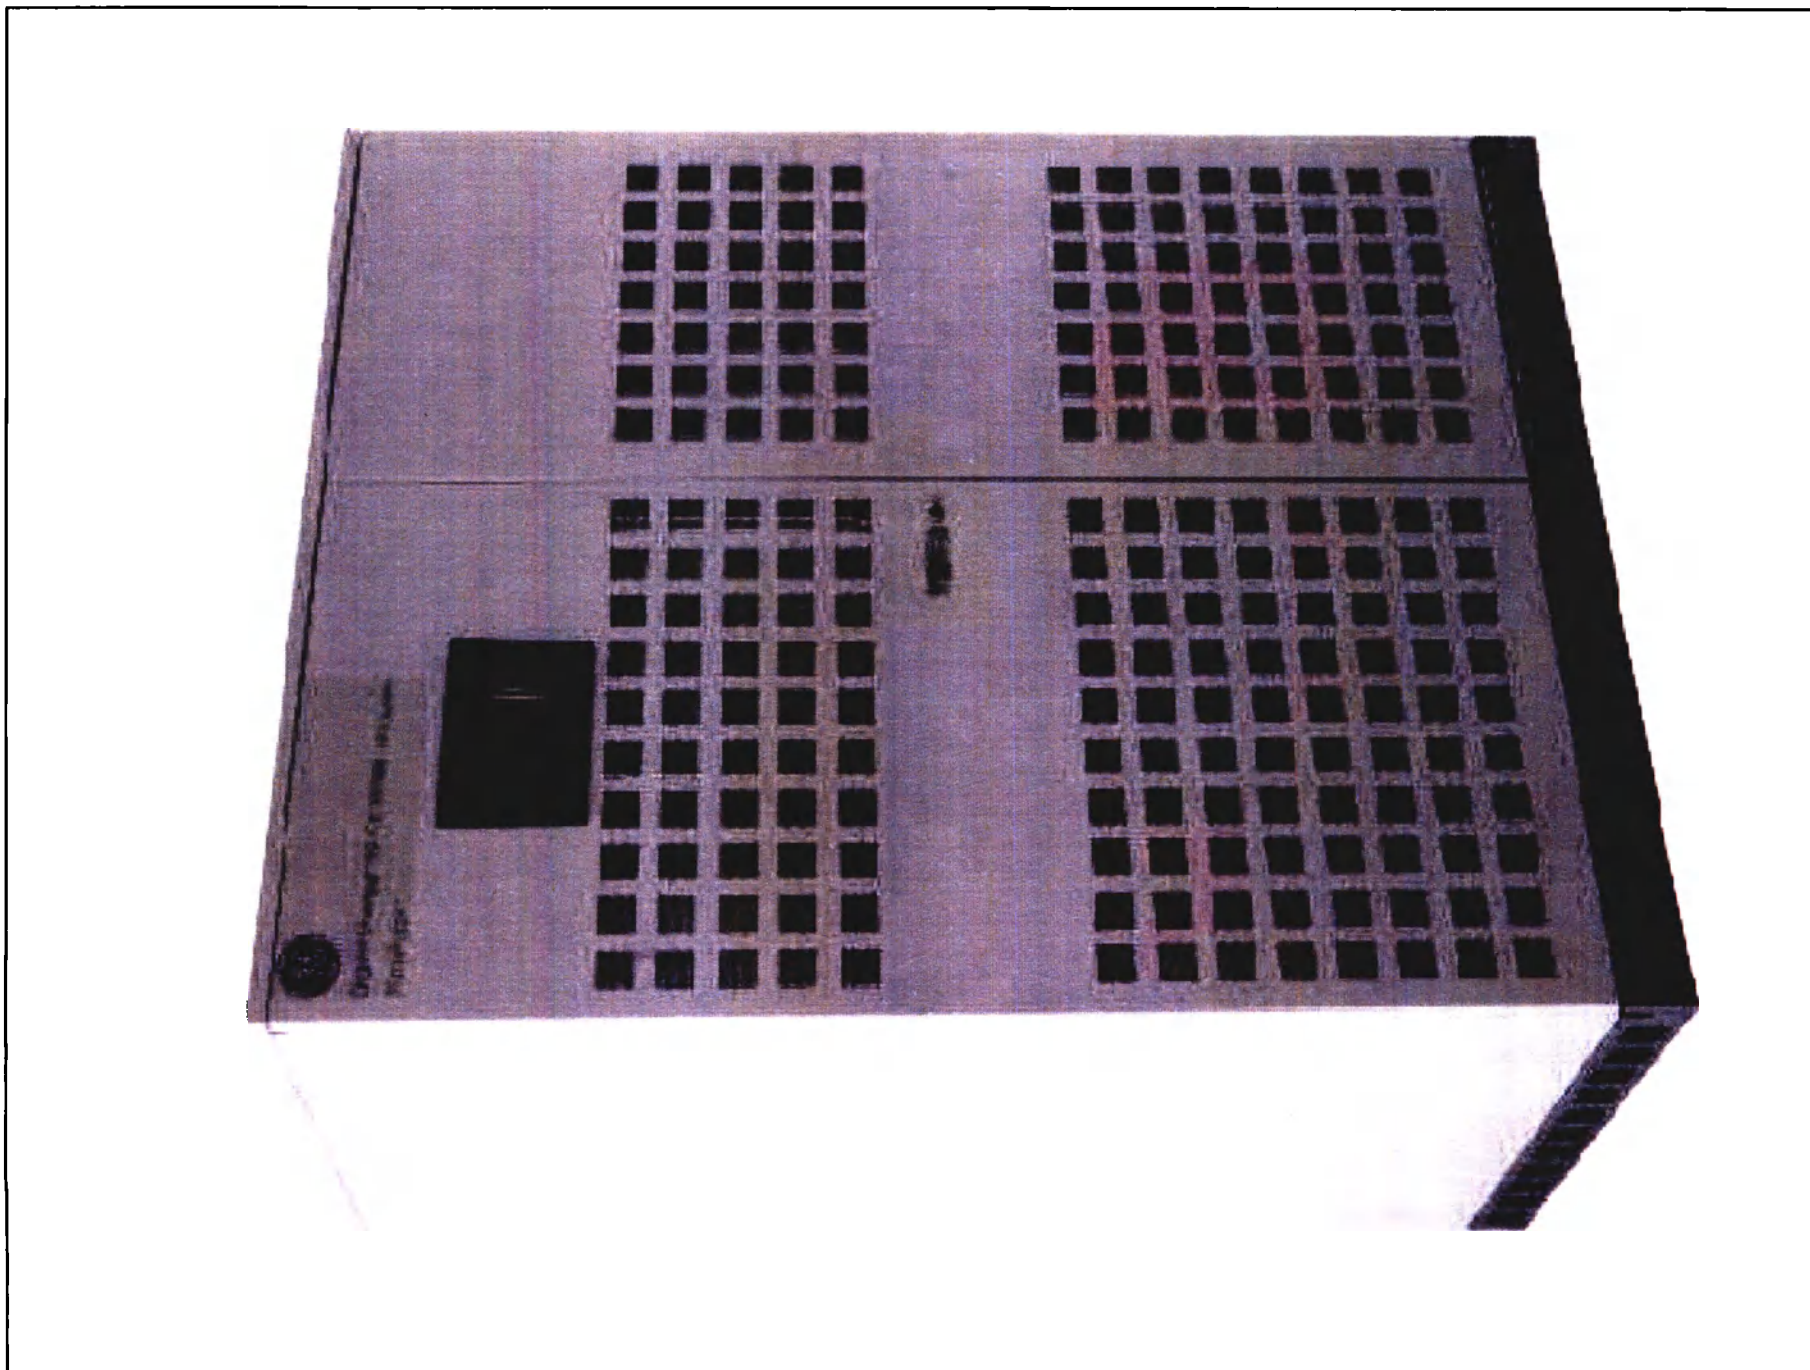


Рисунок 112. Источник бесперебойного питания ангиографической системы внешний.

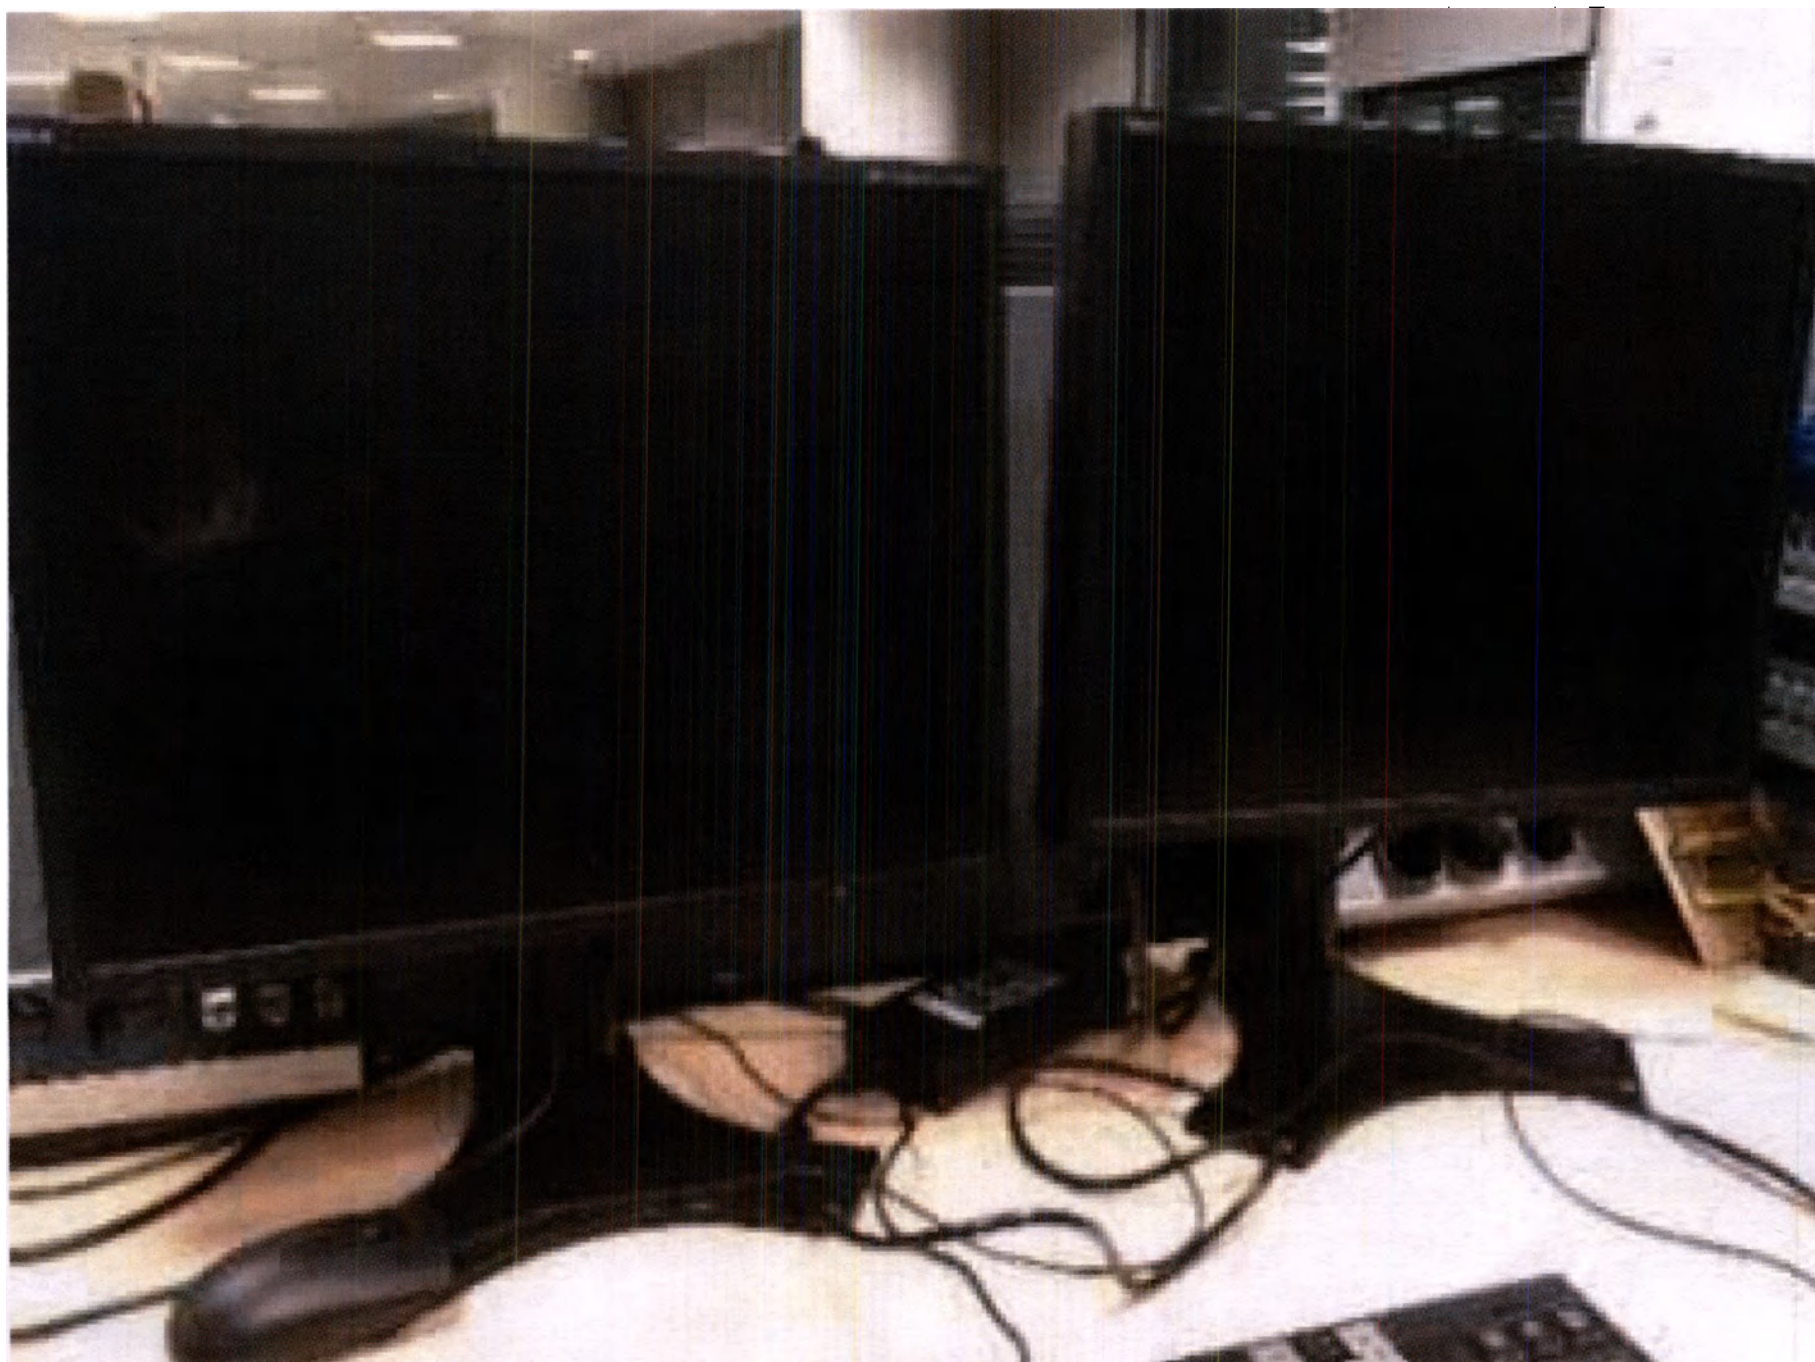


Рисунок 113. Мониторы станции сбора медицинских данных.



Рисунок 114. Специальные медицинские мониторы постоянного изображения.


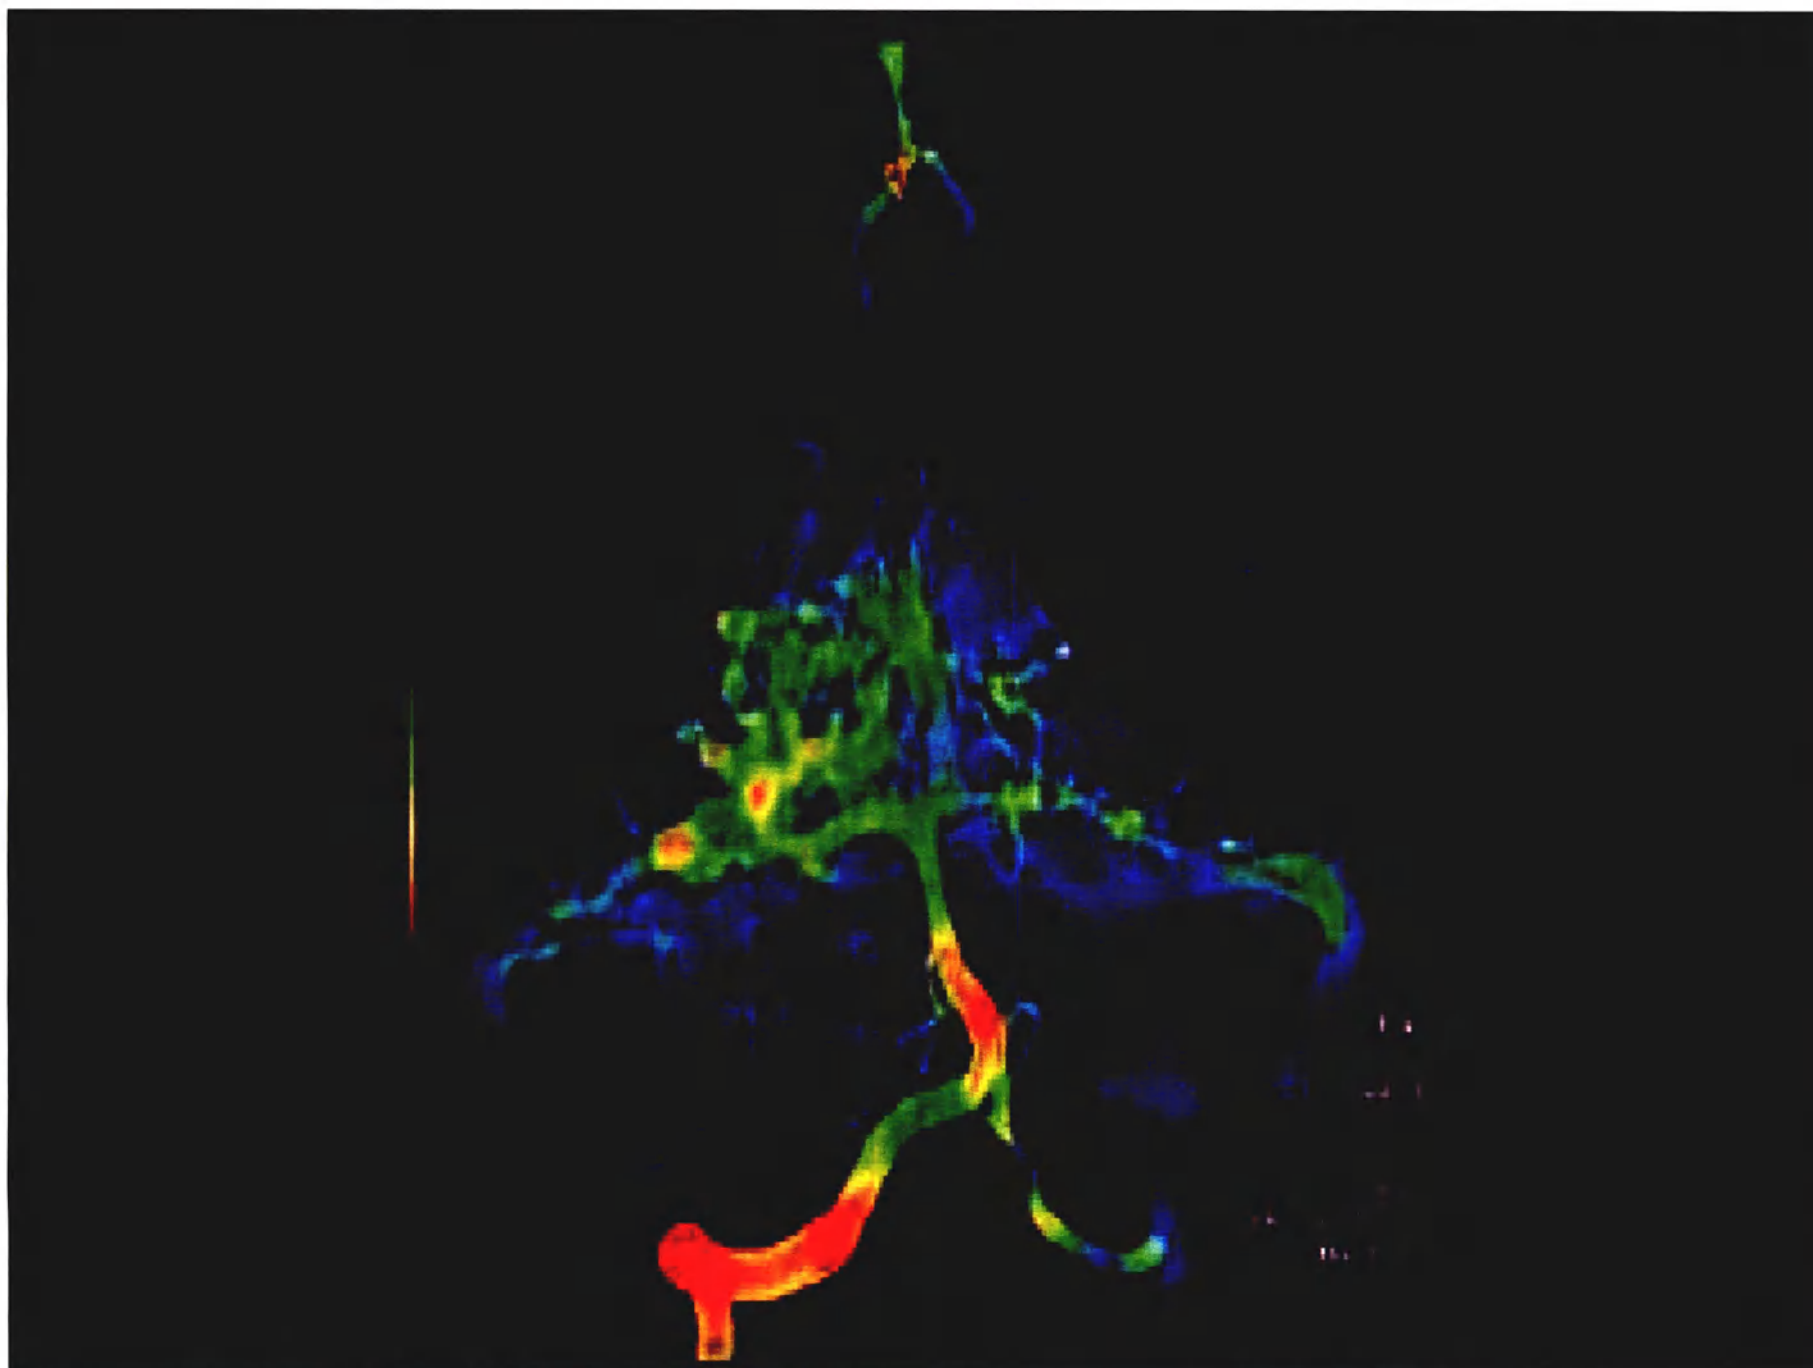


Рисунок 116. Программный модуль для получения суммационных изображений AngioViz.

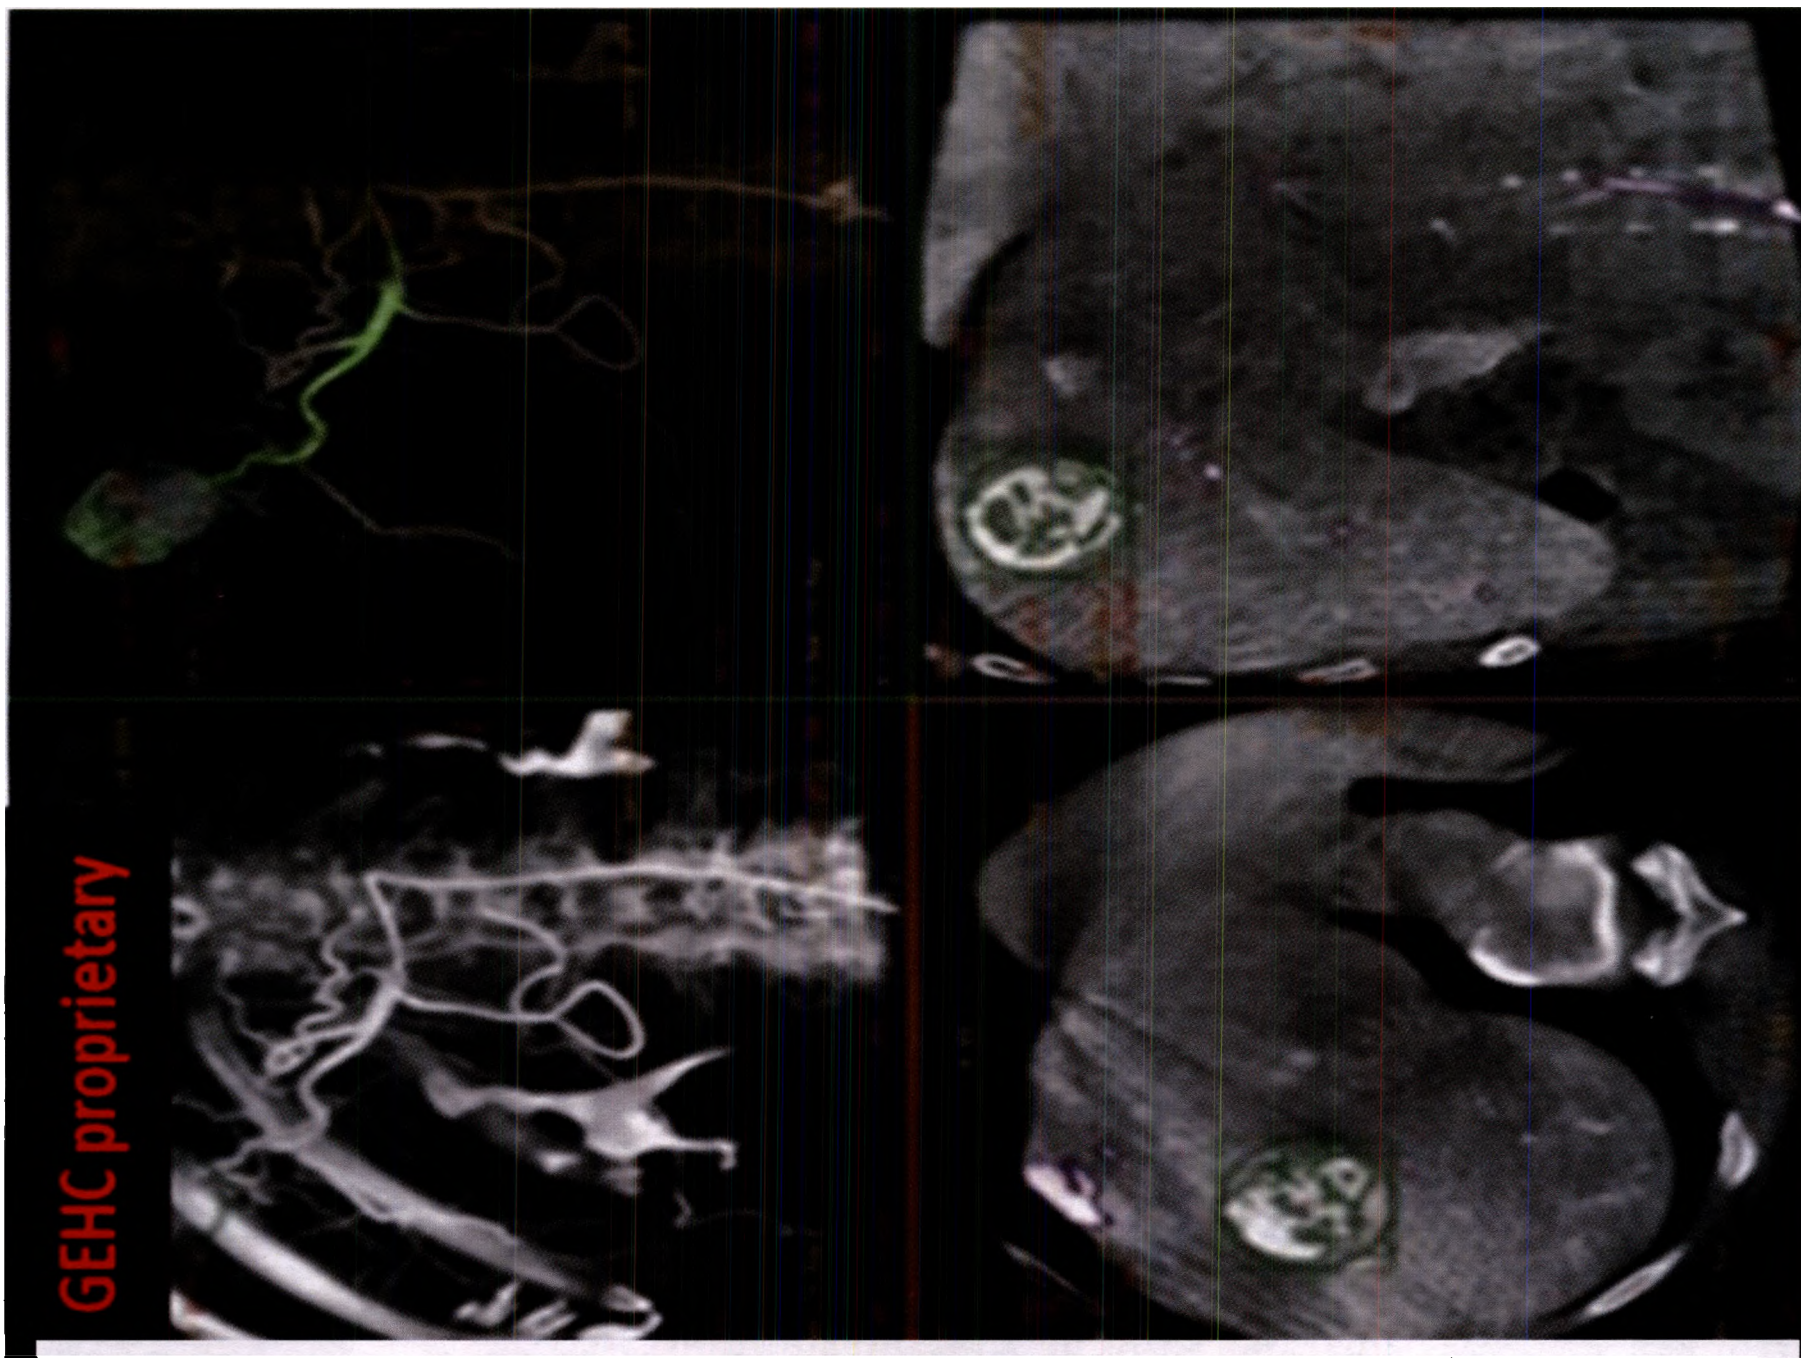

GEHC proprietary

Рисунок 117.

Программный модуль для автоматического определения питающих сосудов на трехмерном изображении с функцией совмещения с текущим рентгеноскопическим изображением.

GEHC proprietary

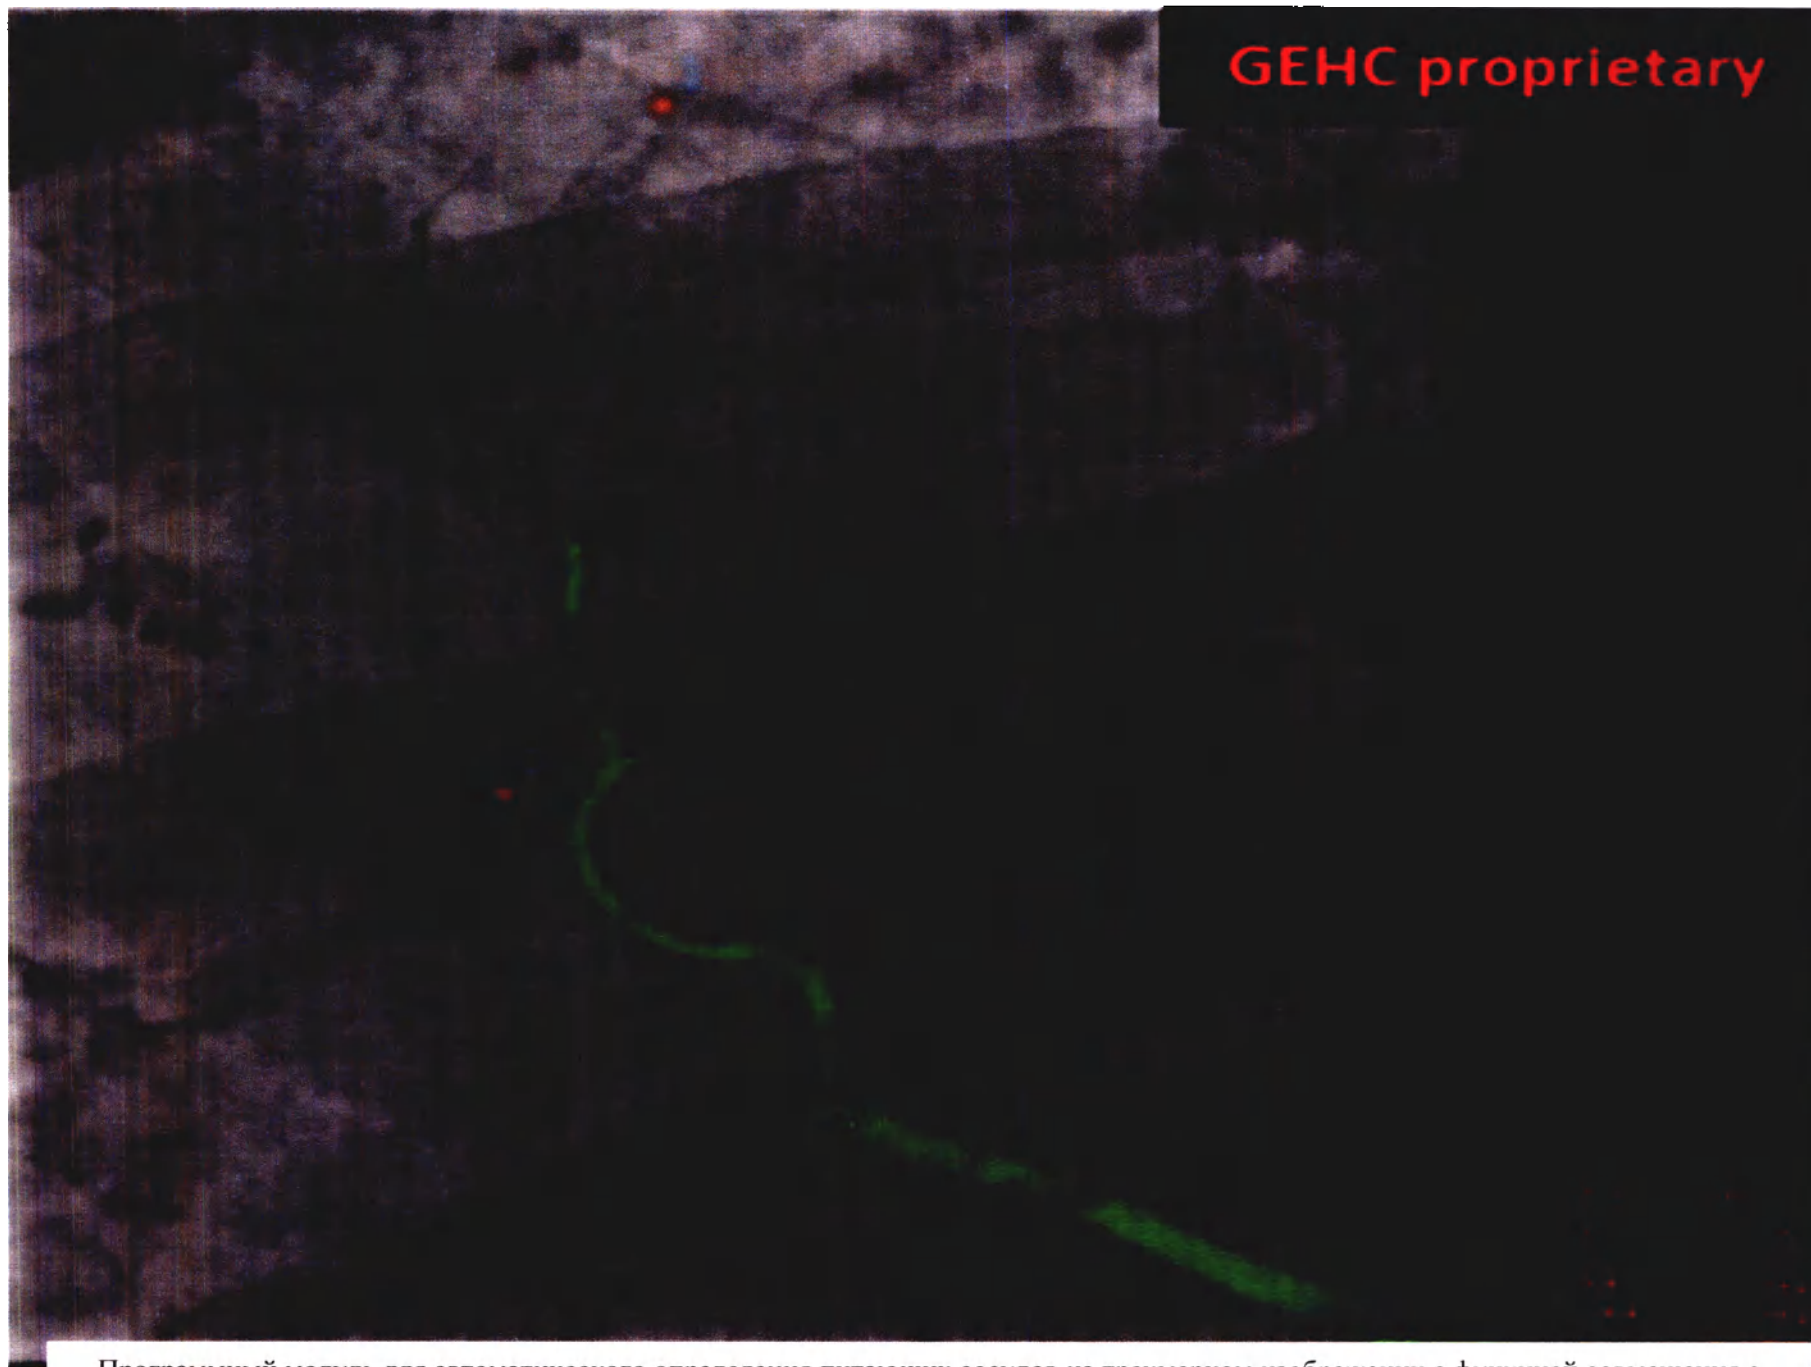


Рисунок 118.

Программный модуль для автоматического определения питающих сосудов на трехмерном изображении с функцией совмещения с текущим рентгеноскопическим изображением.

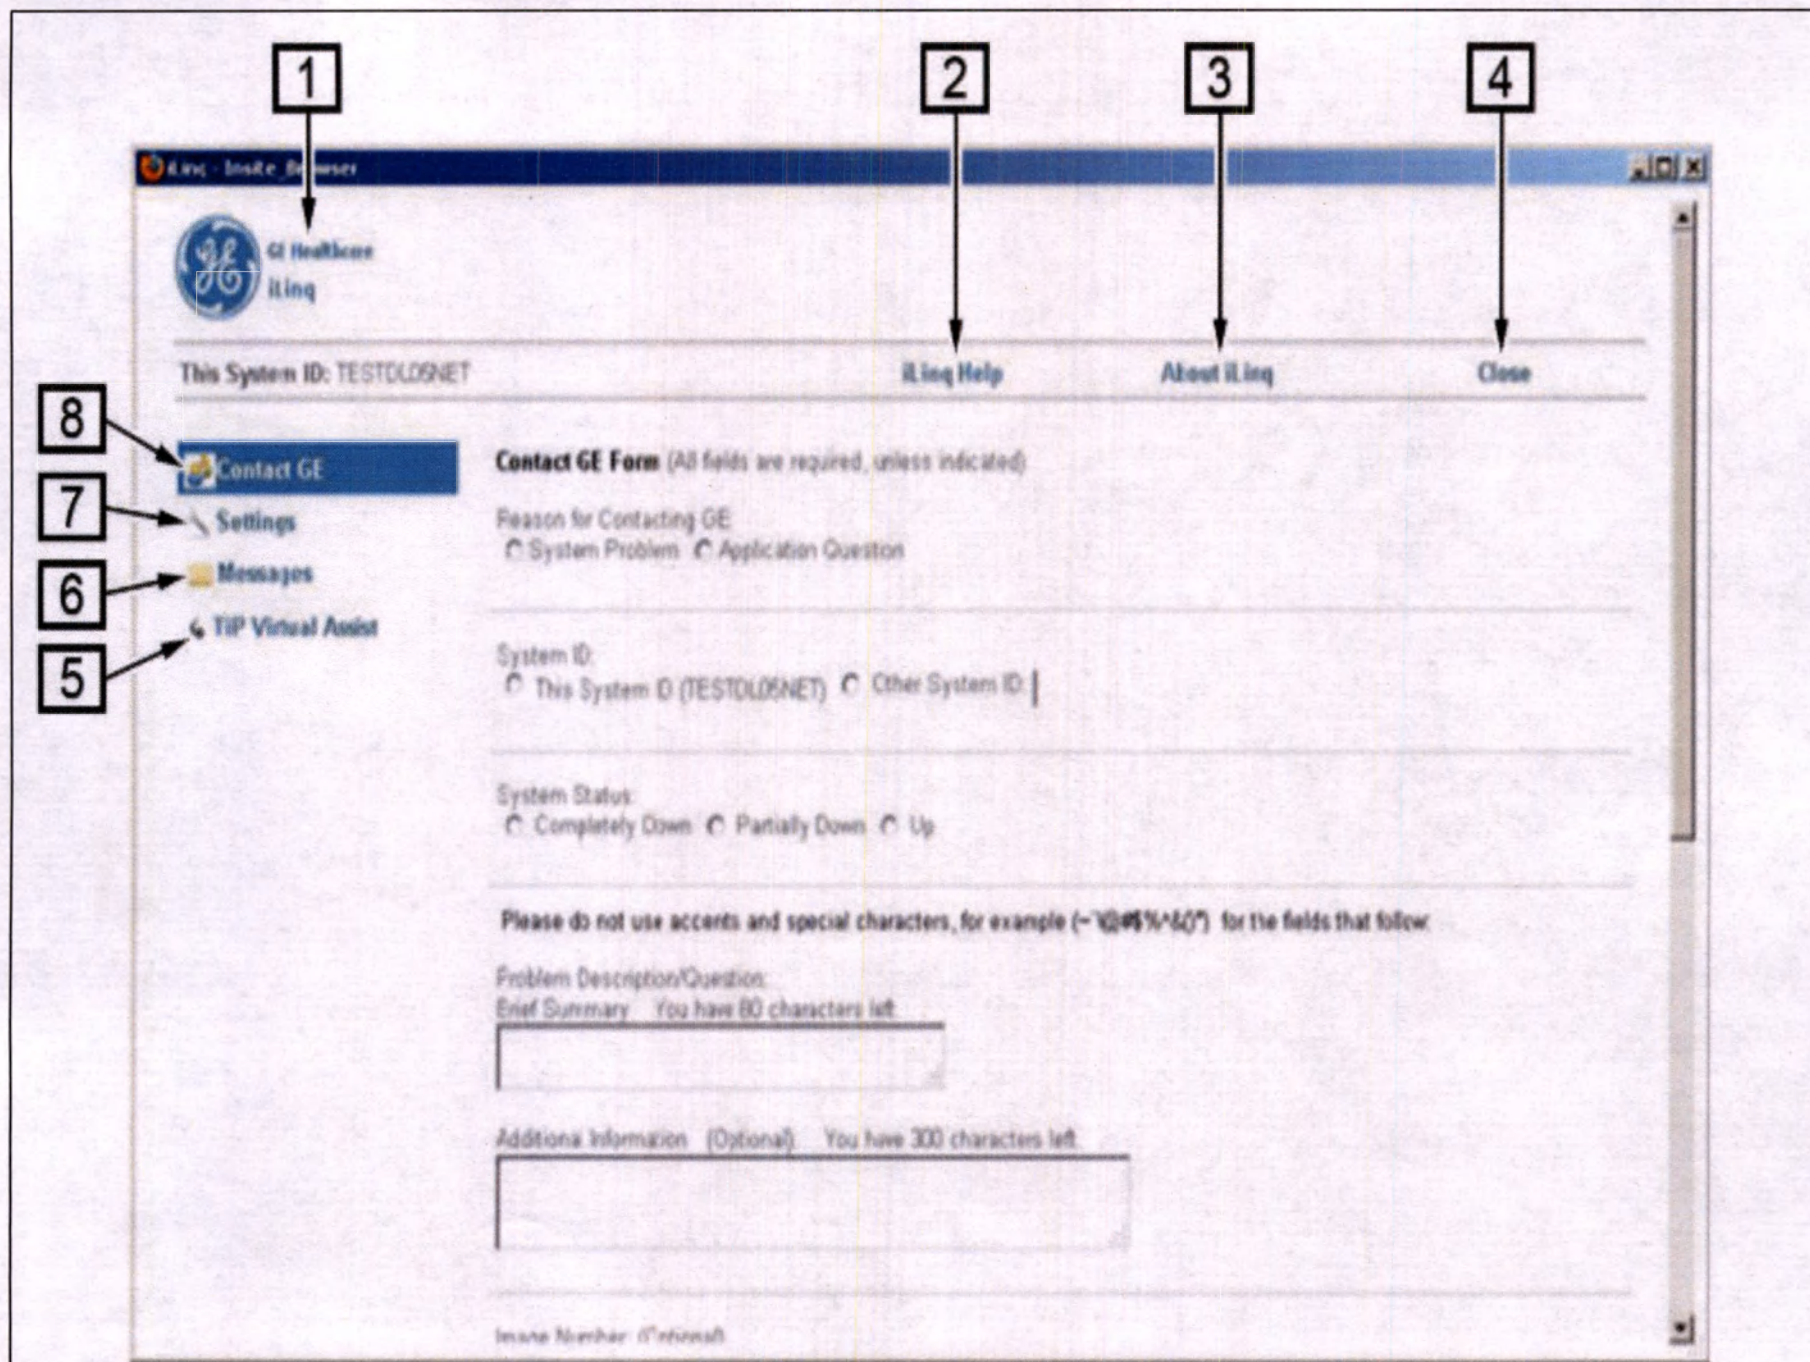


Рисунок 119. Программный модуль для удаленного доступа к рабочей станции.



Рисунок 120. Рентгенозащитные стекла с рамой.



Рисунок 121. Рентгенозащитные ширмы для нижней части тела.

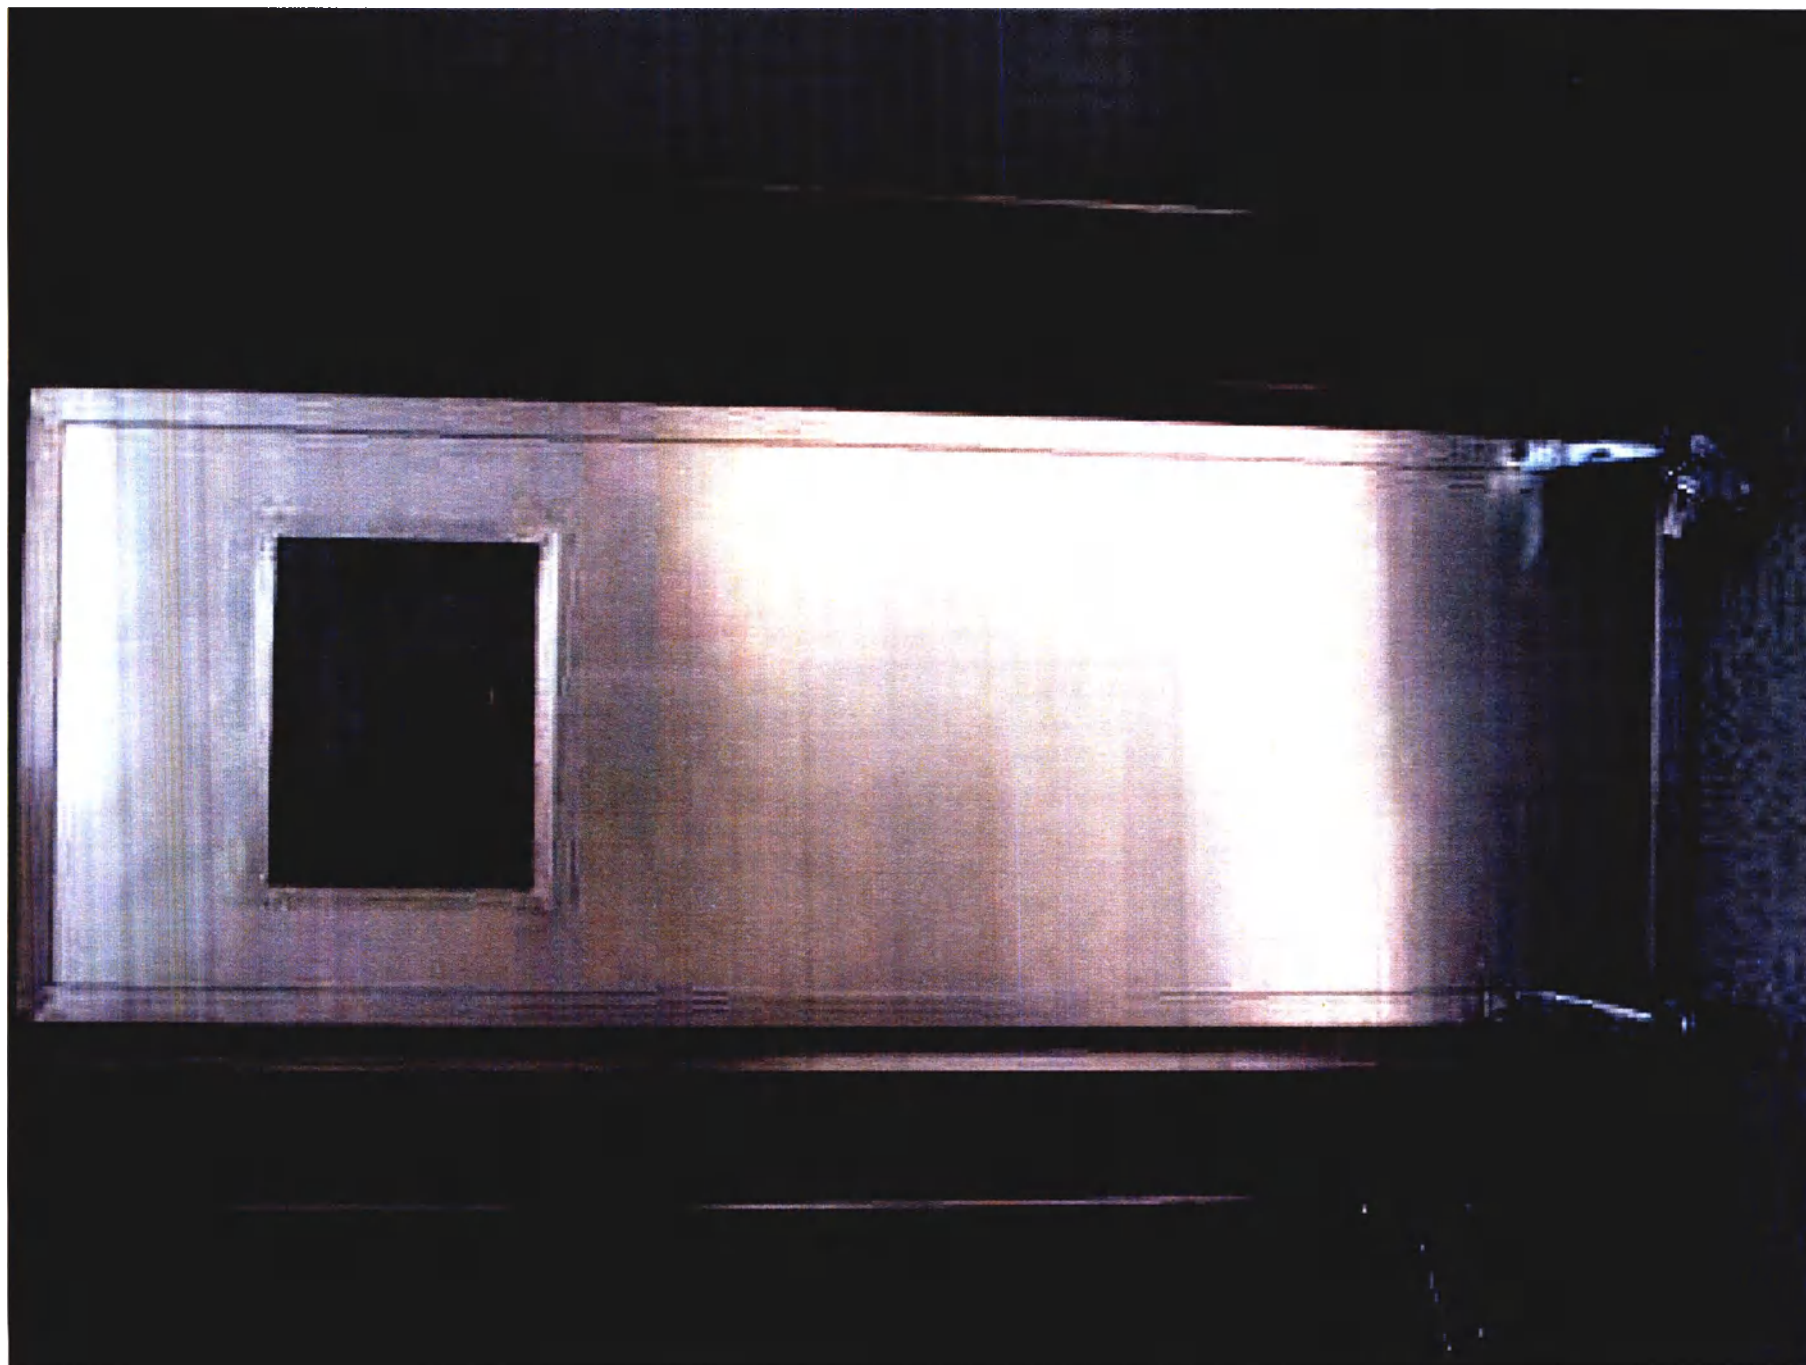


Рисунок 122. Мобильная рентгенозащитная кабина.

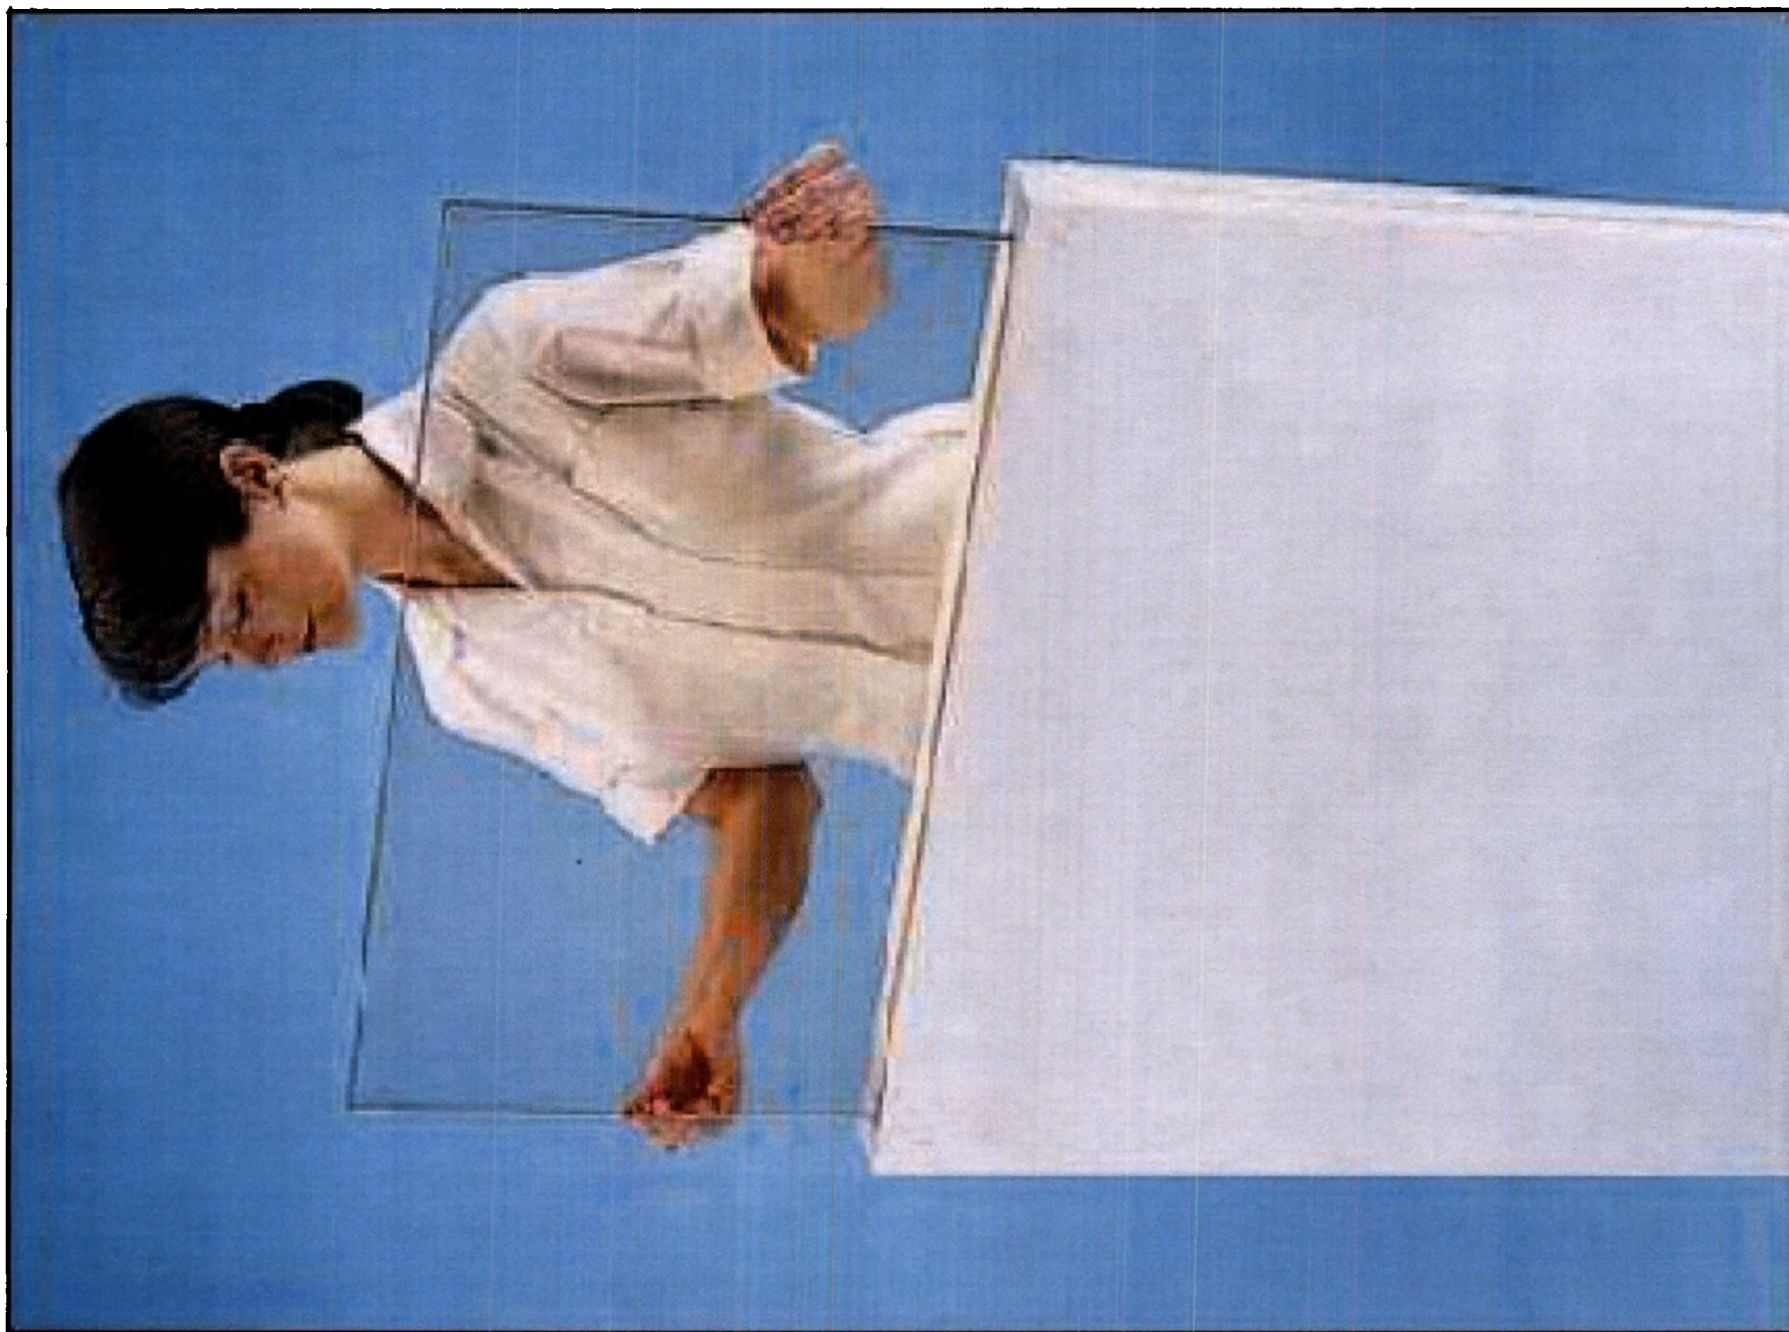


Рисунок 123. Съёмный рентгенозащитный экран для верхней части тела.

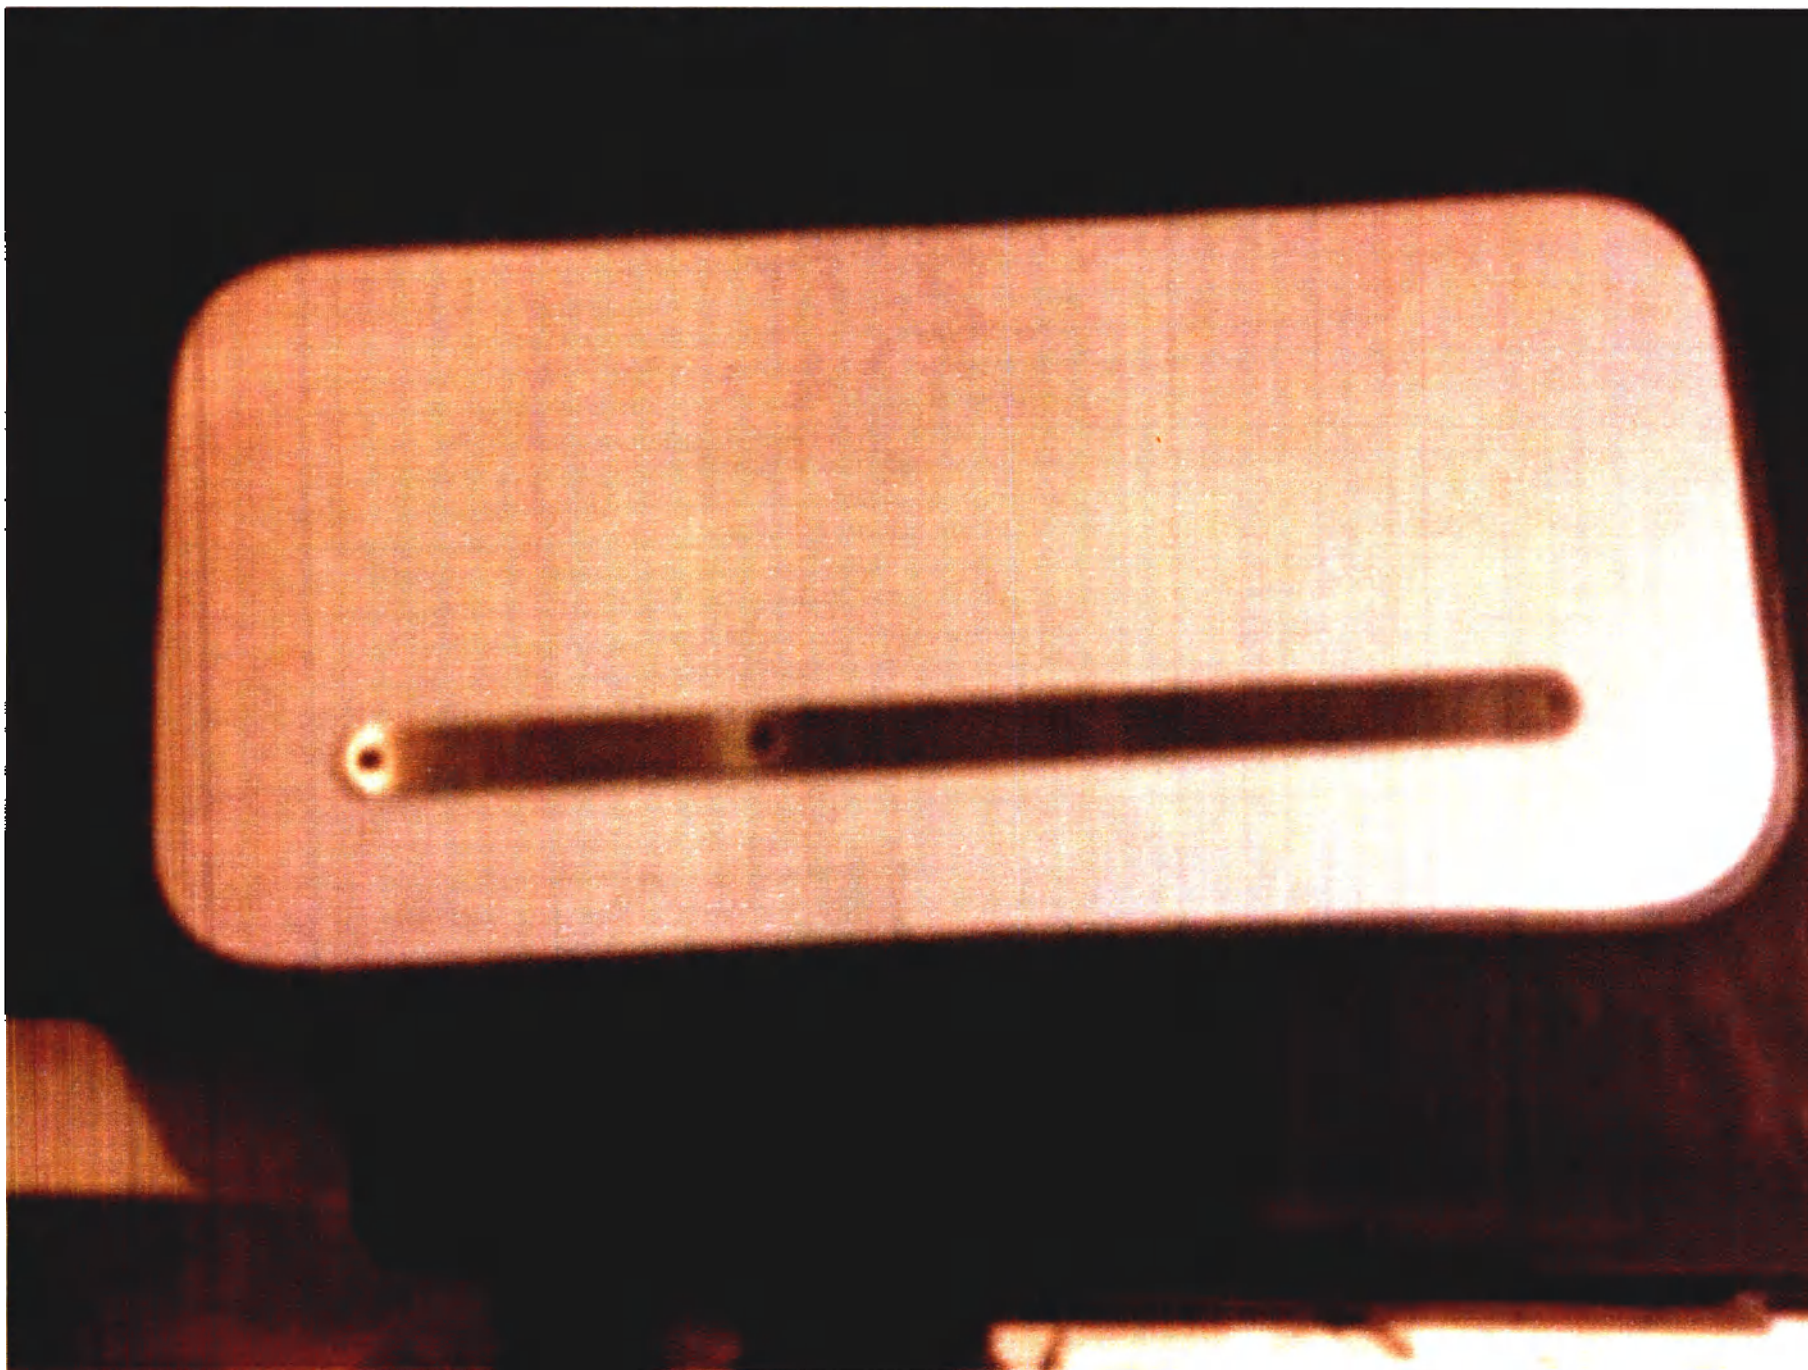


Рисунок 124. Двойной поворотный рентгенозащитный экран для верхней части тела.



Рисунок 125. Экран защиты от рассеянного излучения.

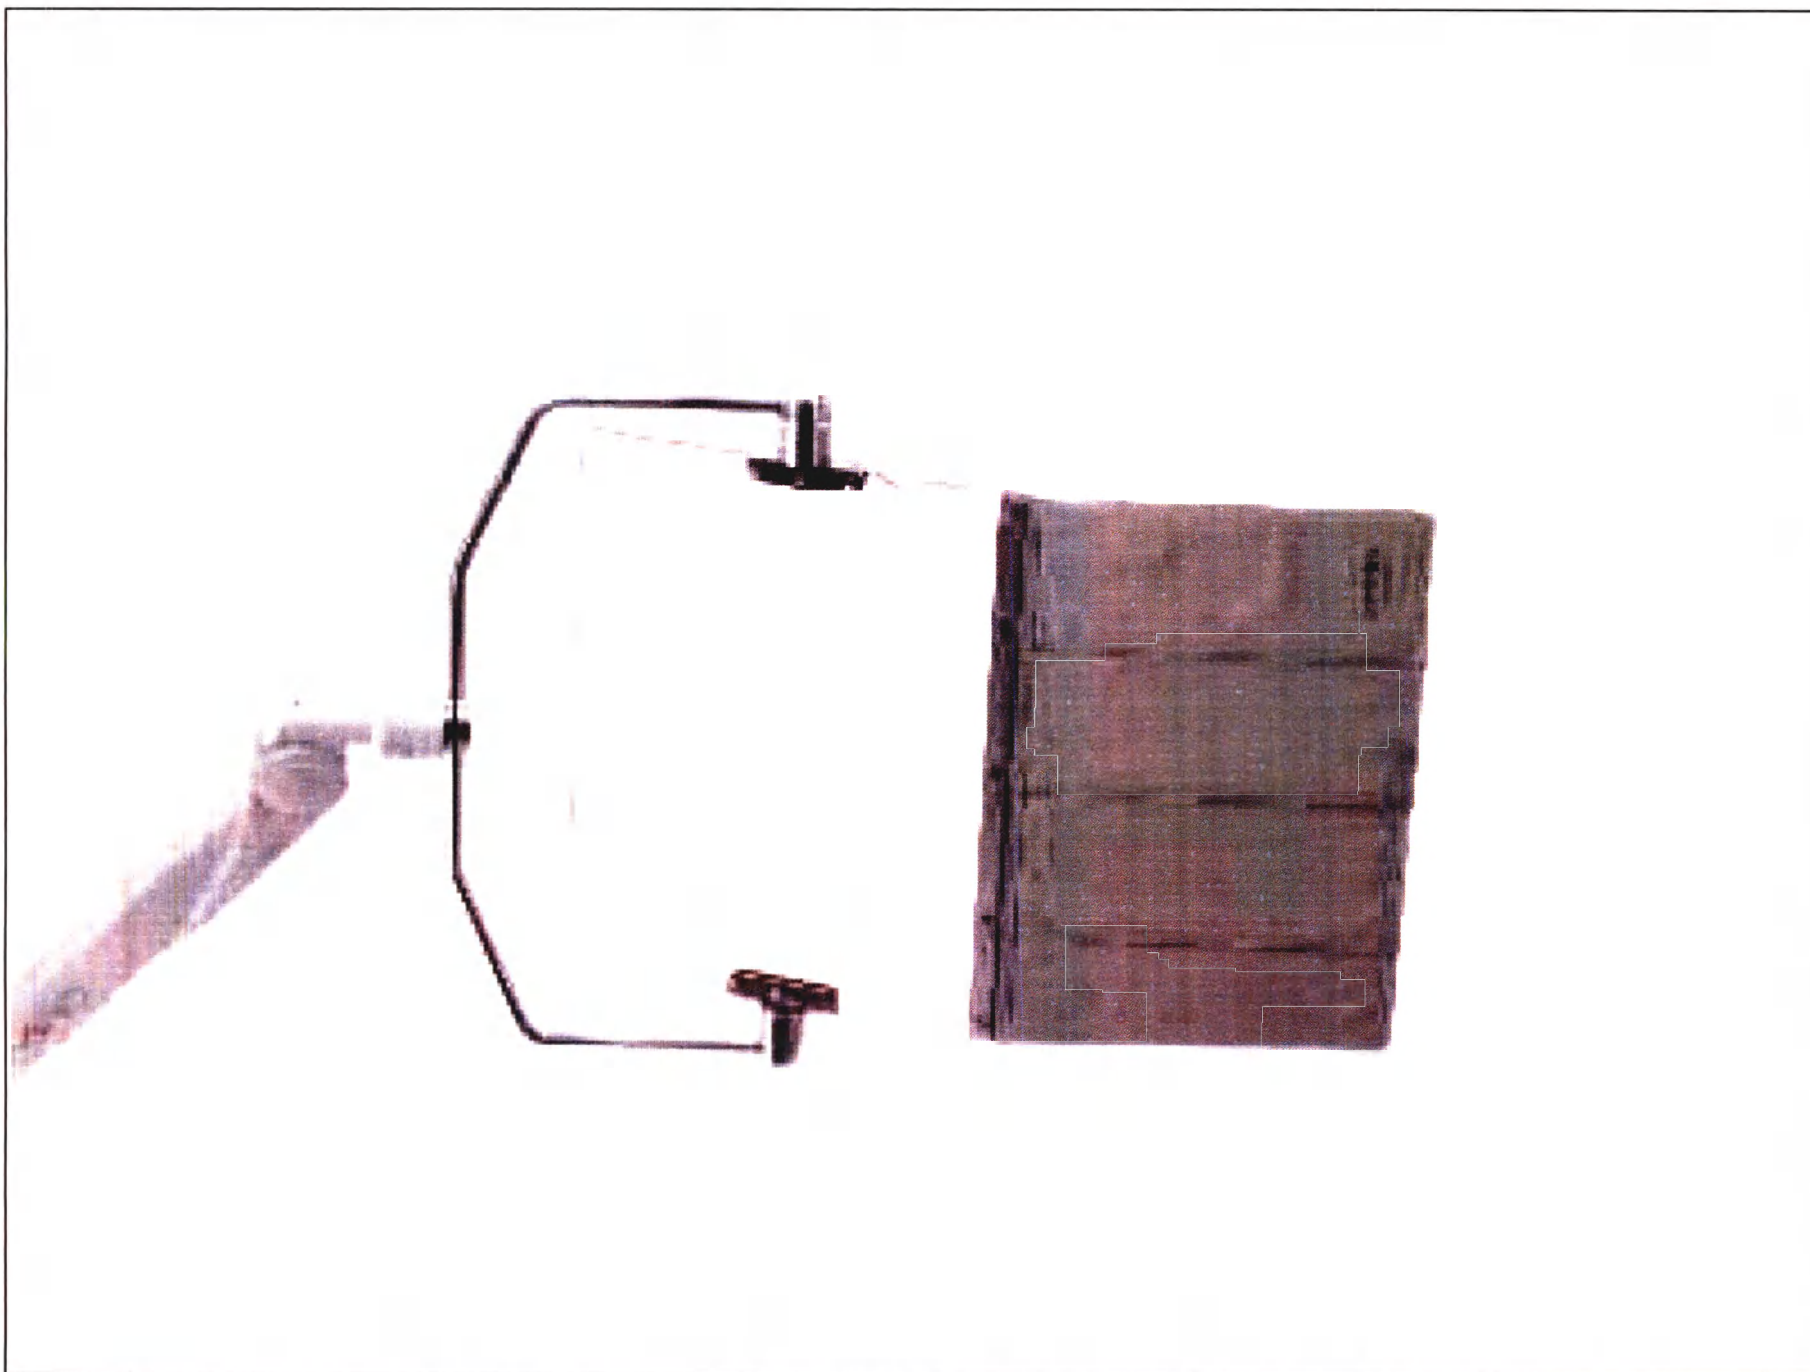


Рисунок 126. Рентгенозащитная ширма потолочного крепления (без светильника).



Рисунок 127. Настенные вешалки для рентгенозащитных средств.

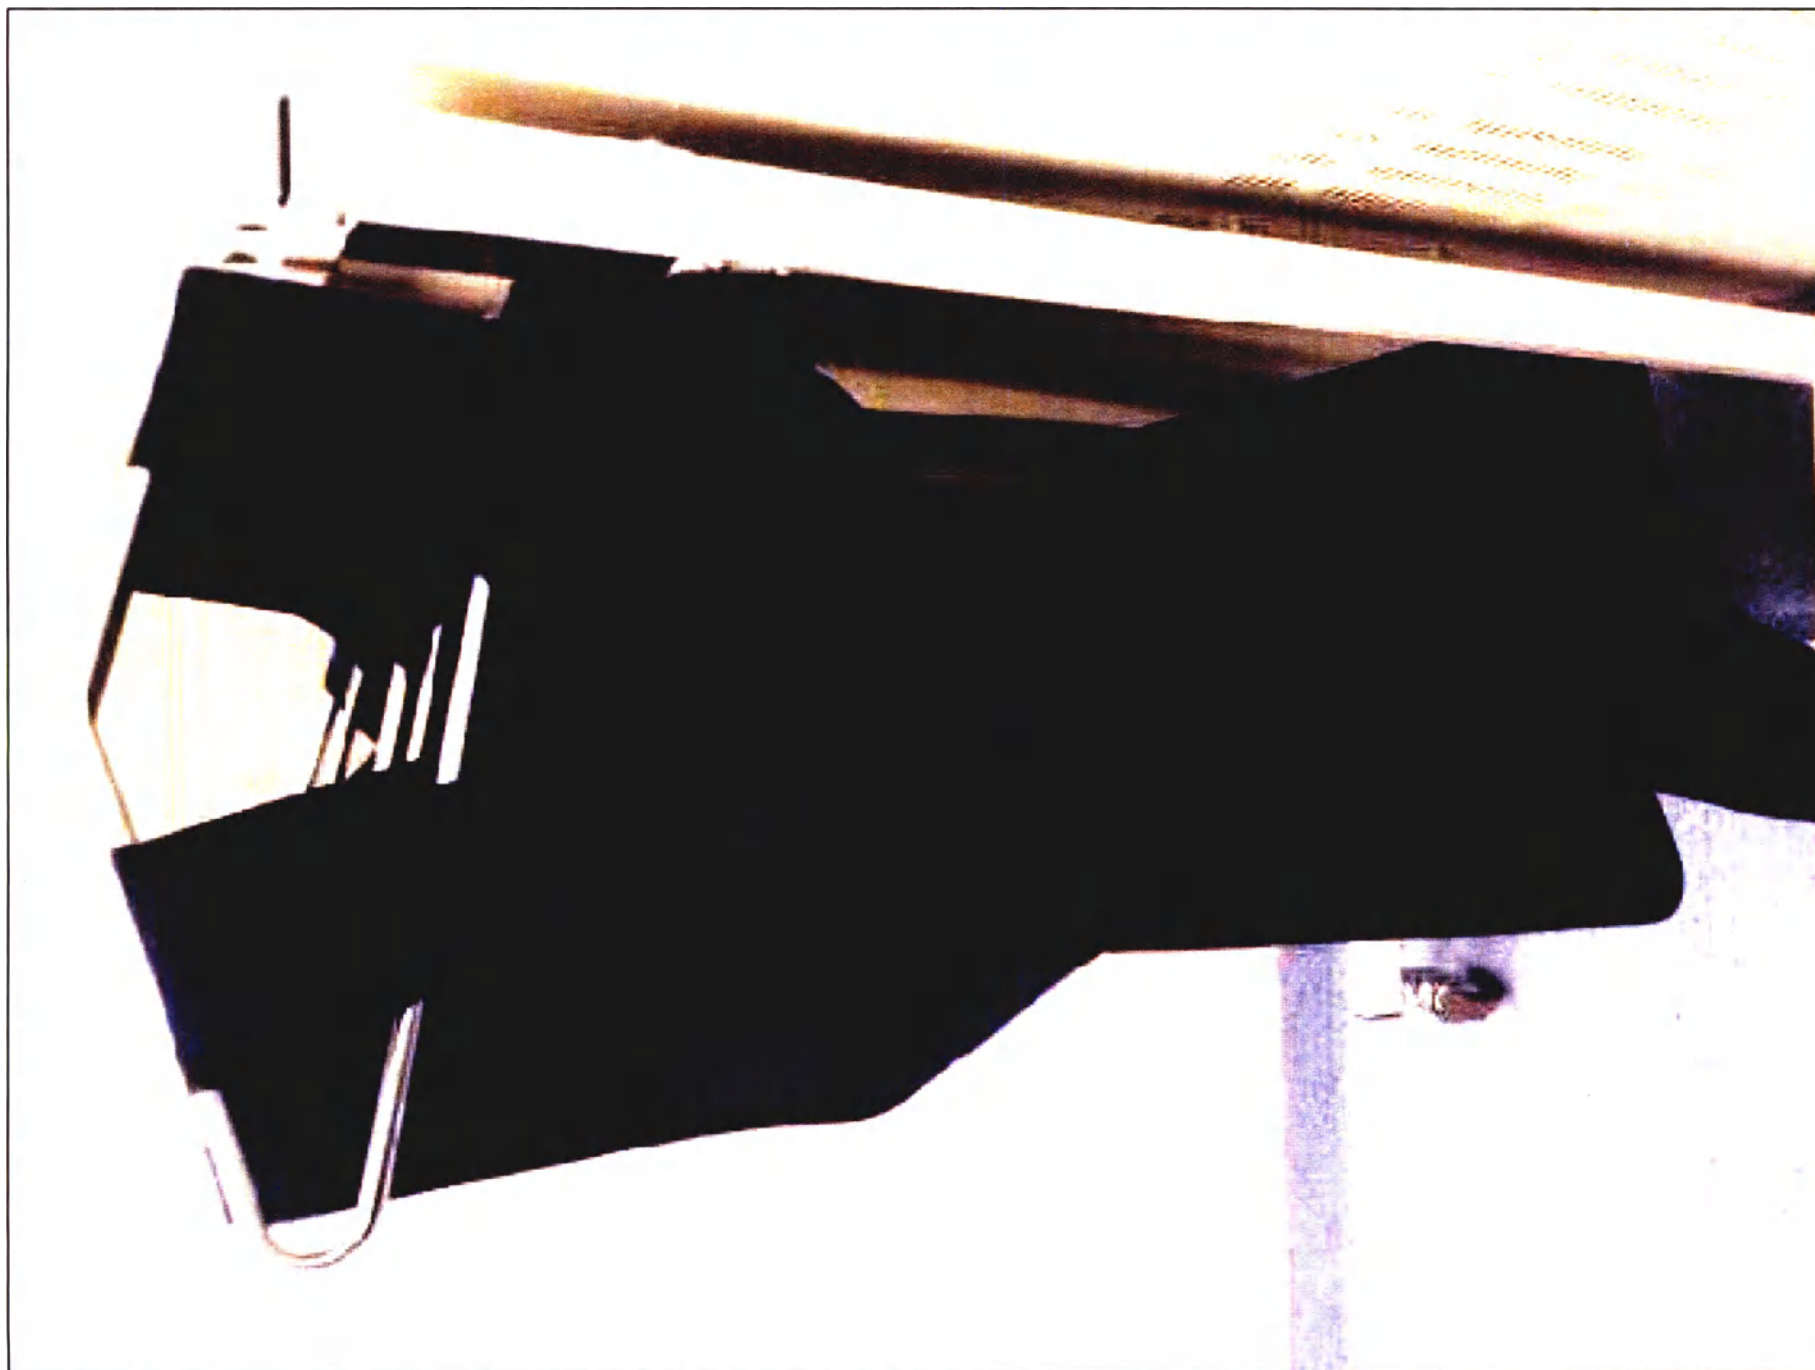


Рисунок 128. Мобильные вешалки для рентгенозащитных средств.

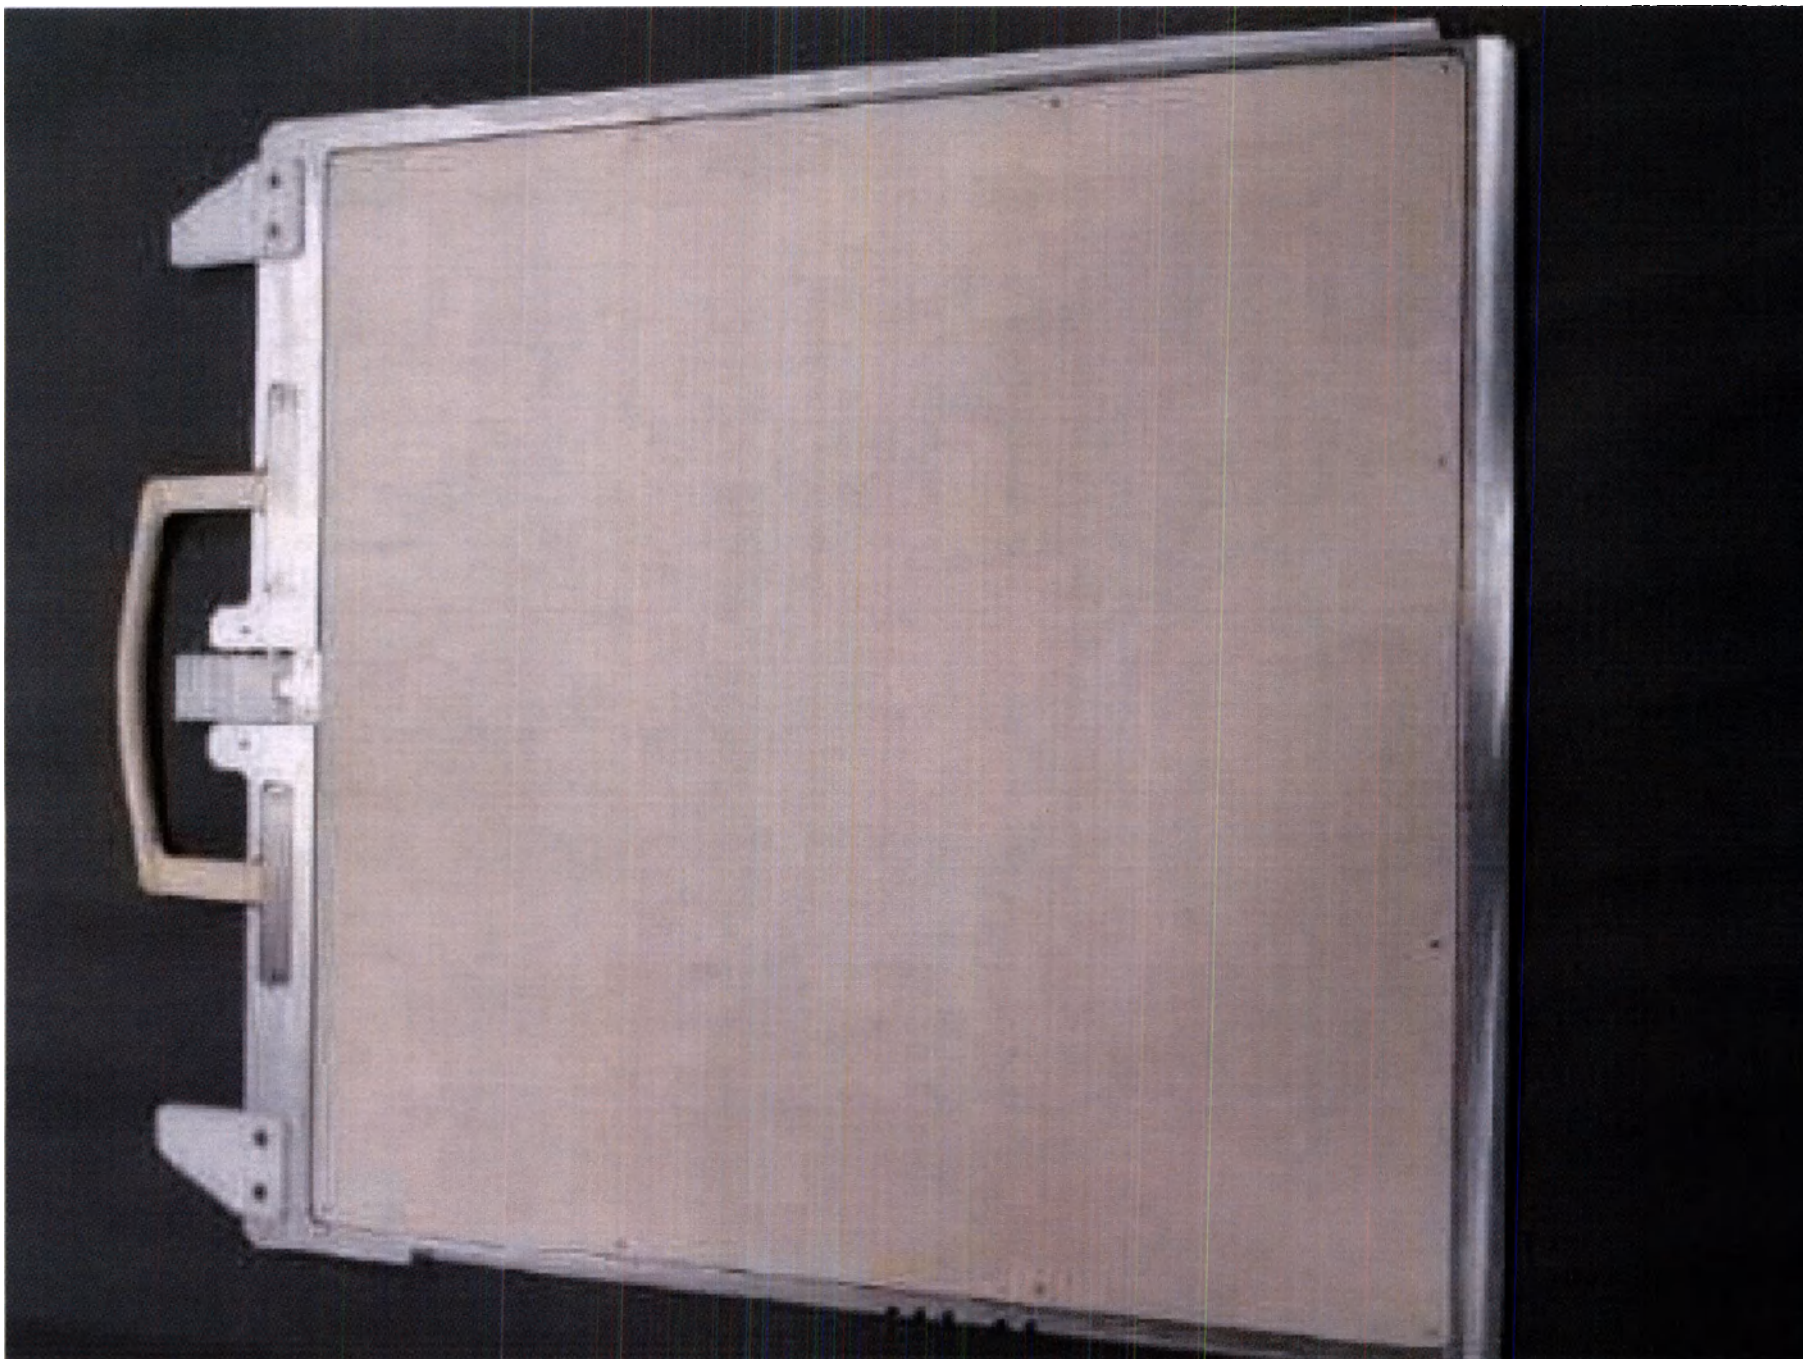


Рисунок 129. Фильтр для педиатрии.


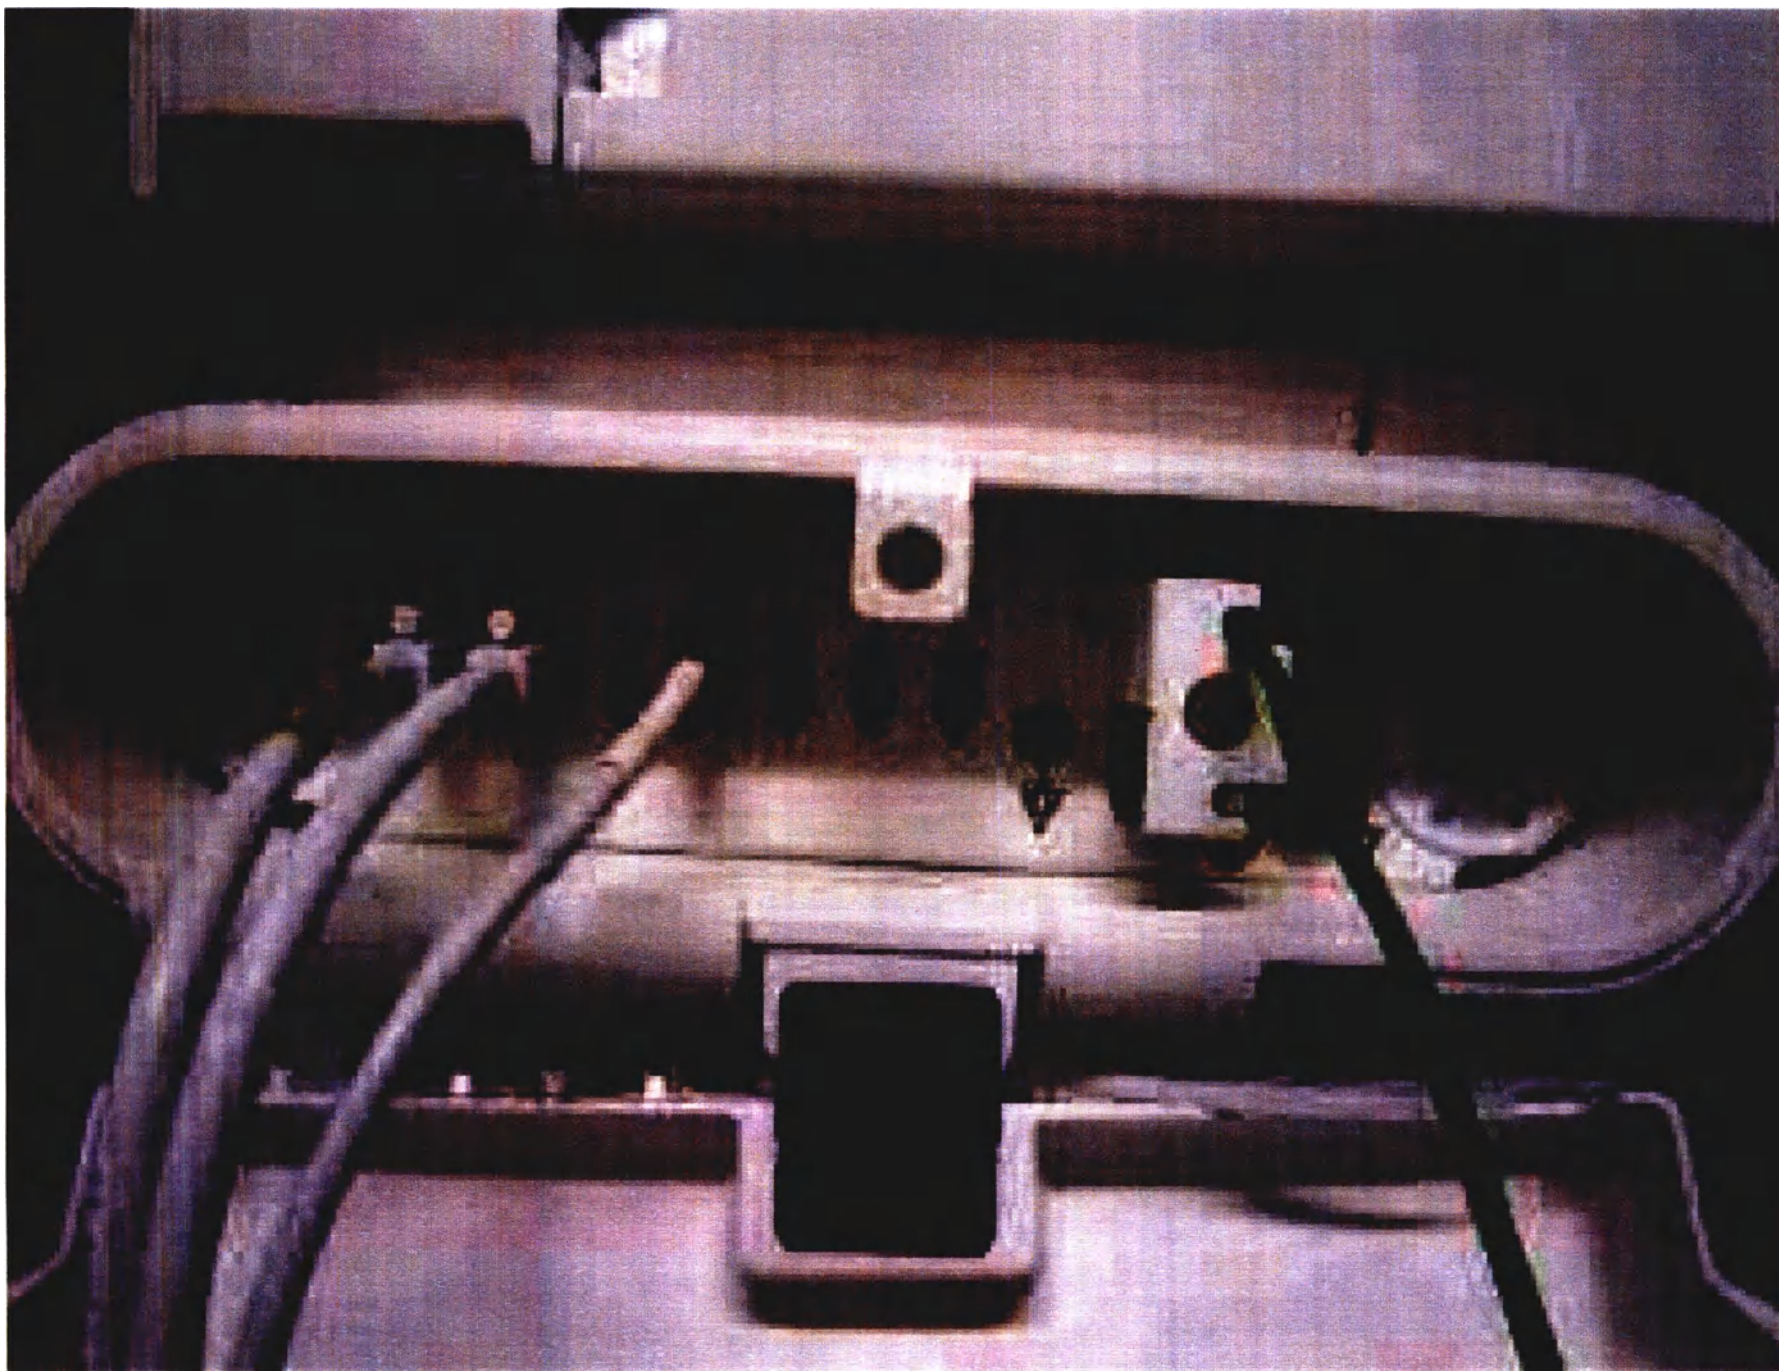



Рисунок 130. Модули для получения и передачи функциональных данных.




Лицензия на программное обеспечение Centricity для сбора, хранения и передачи медицинских данных, на бумажных, оптических, электронных носителях, а также в электронном виде через сеть интернет.

Рисунок 131.

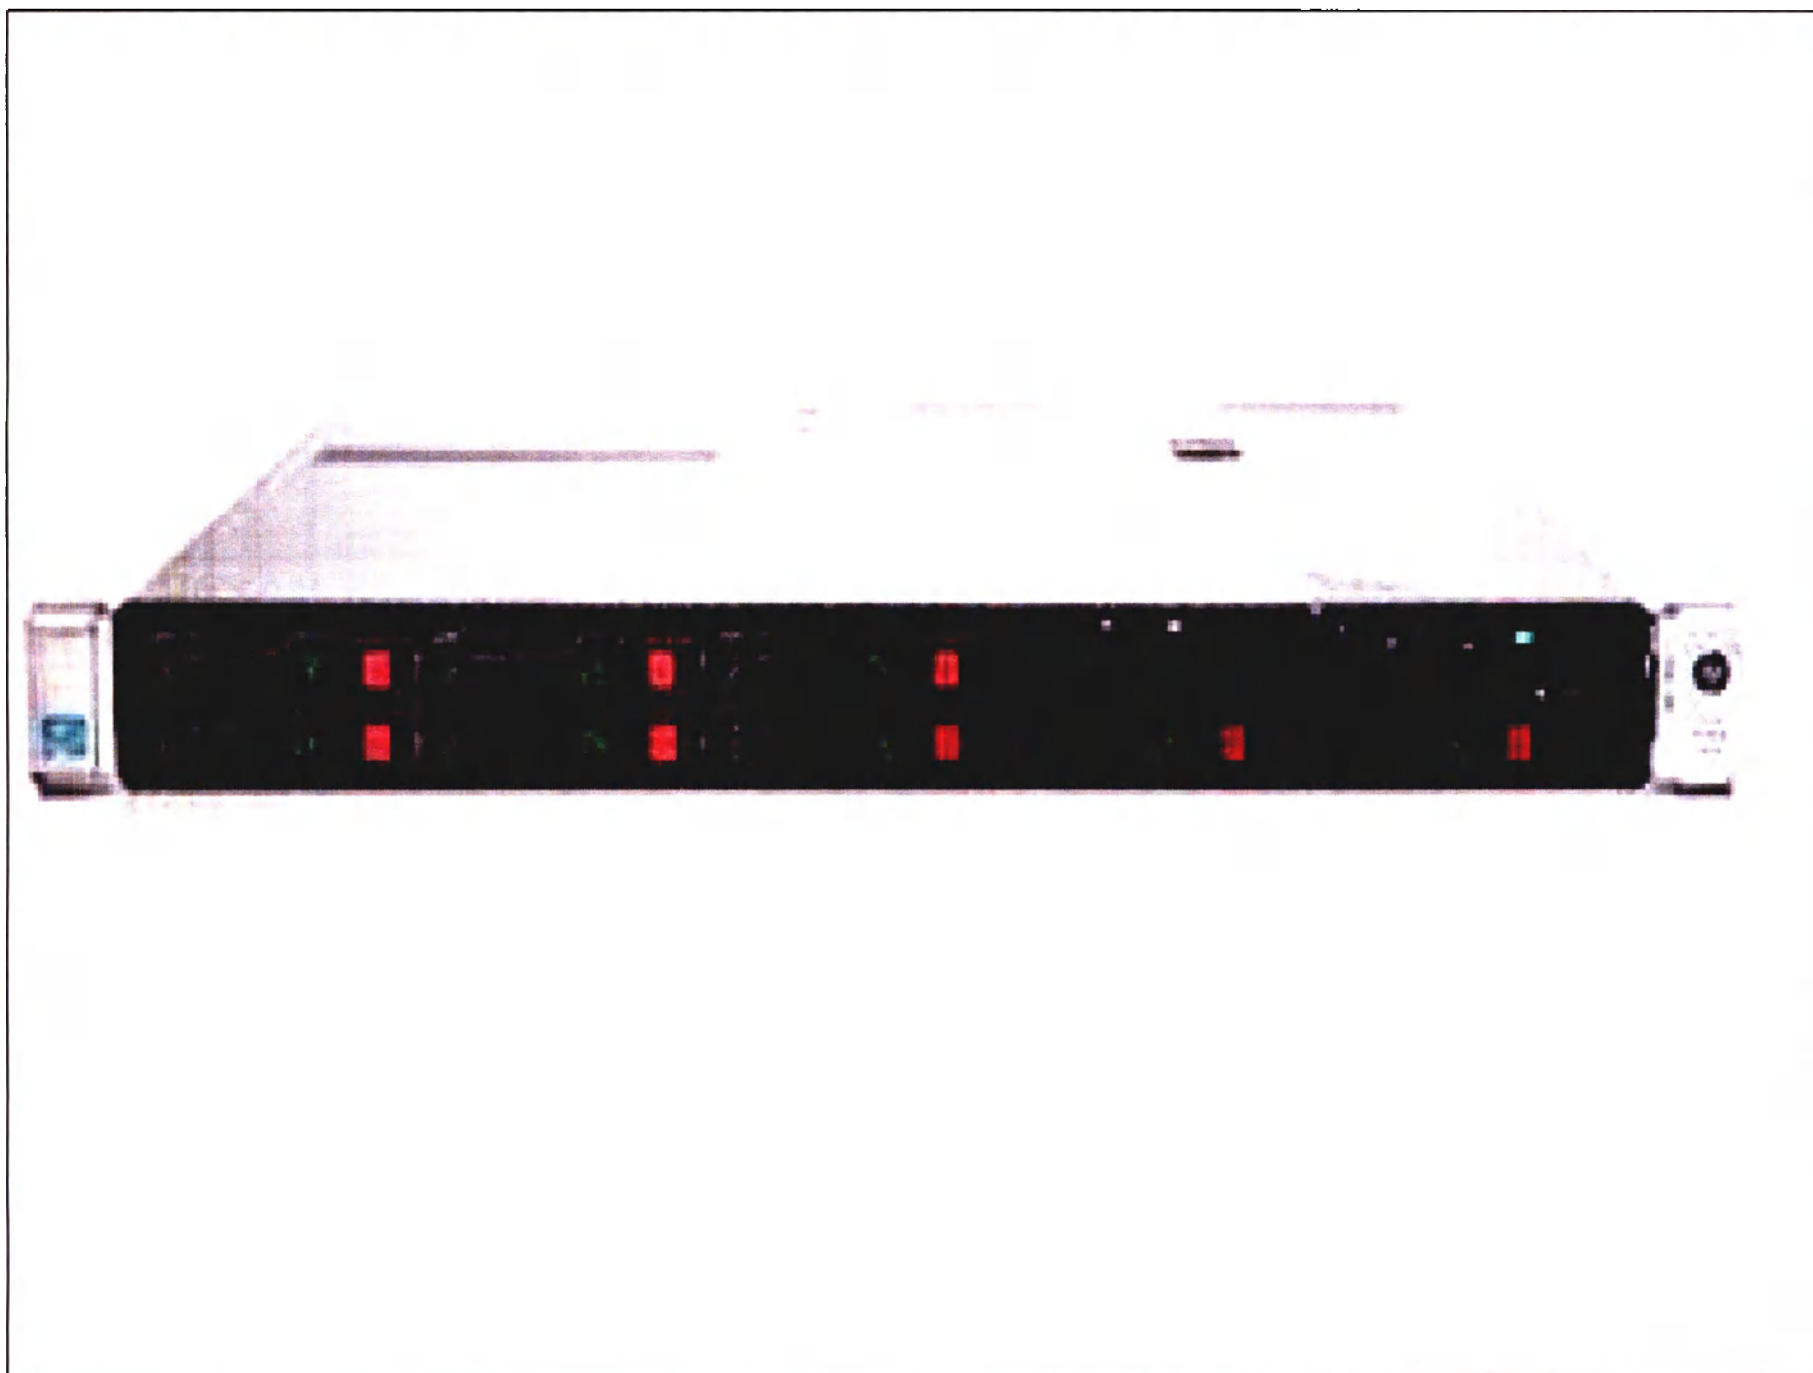

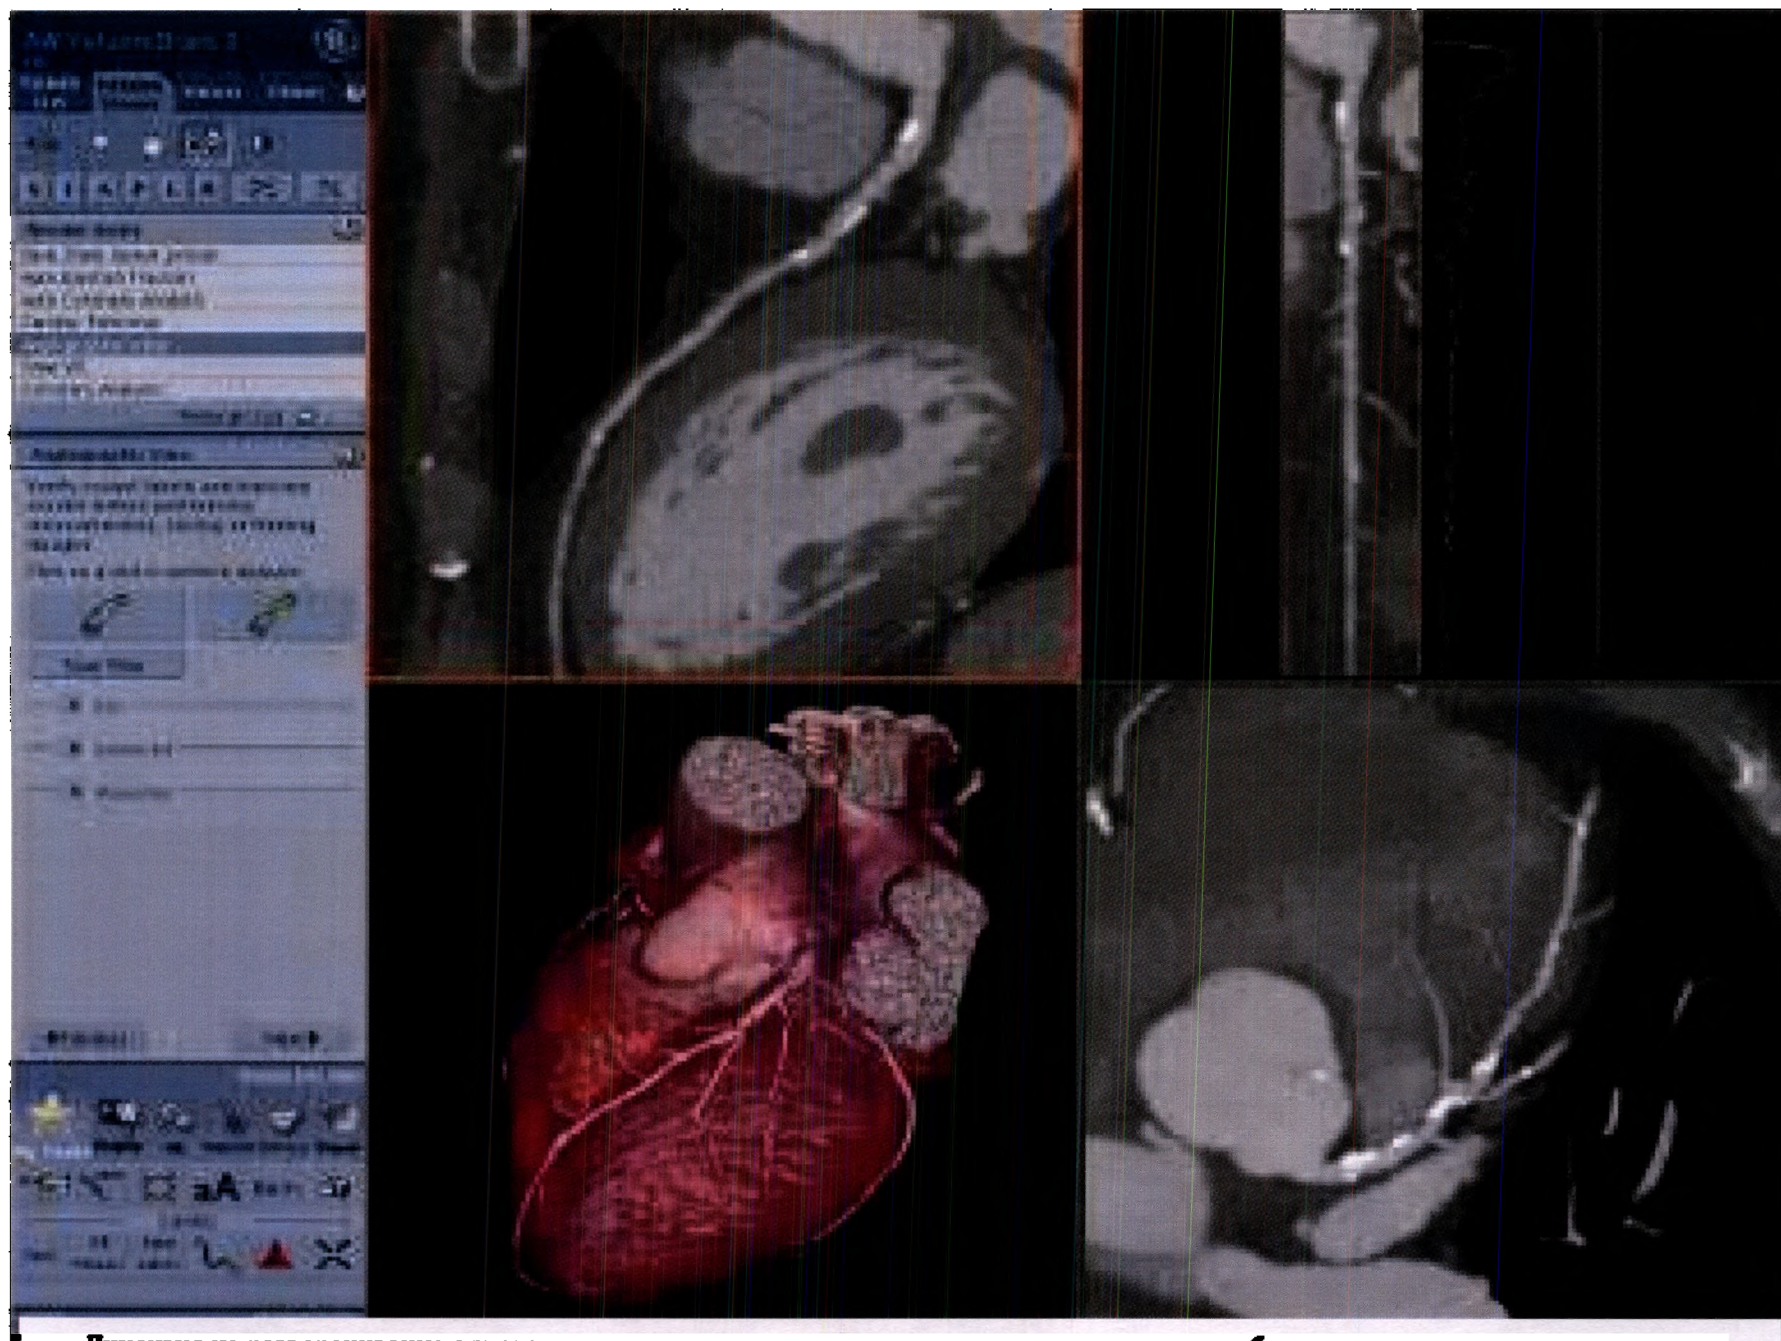


Лицензия на разворачивание одного клинического приложения для одного пользователя, на бумажных, оптических, электронных носителях, а также в электронном виде через сеть интернет.

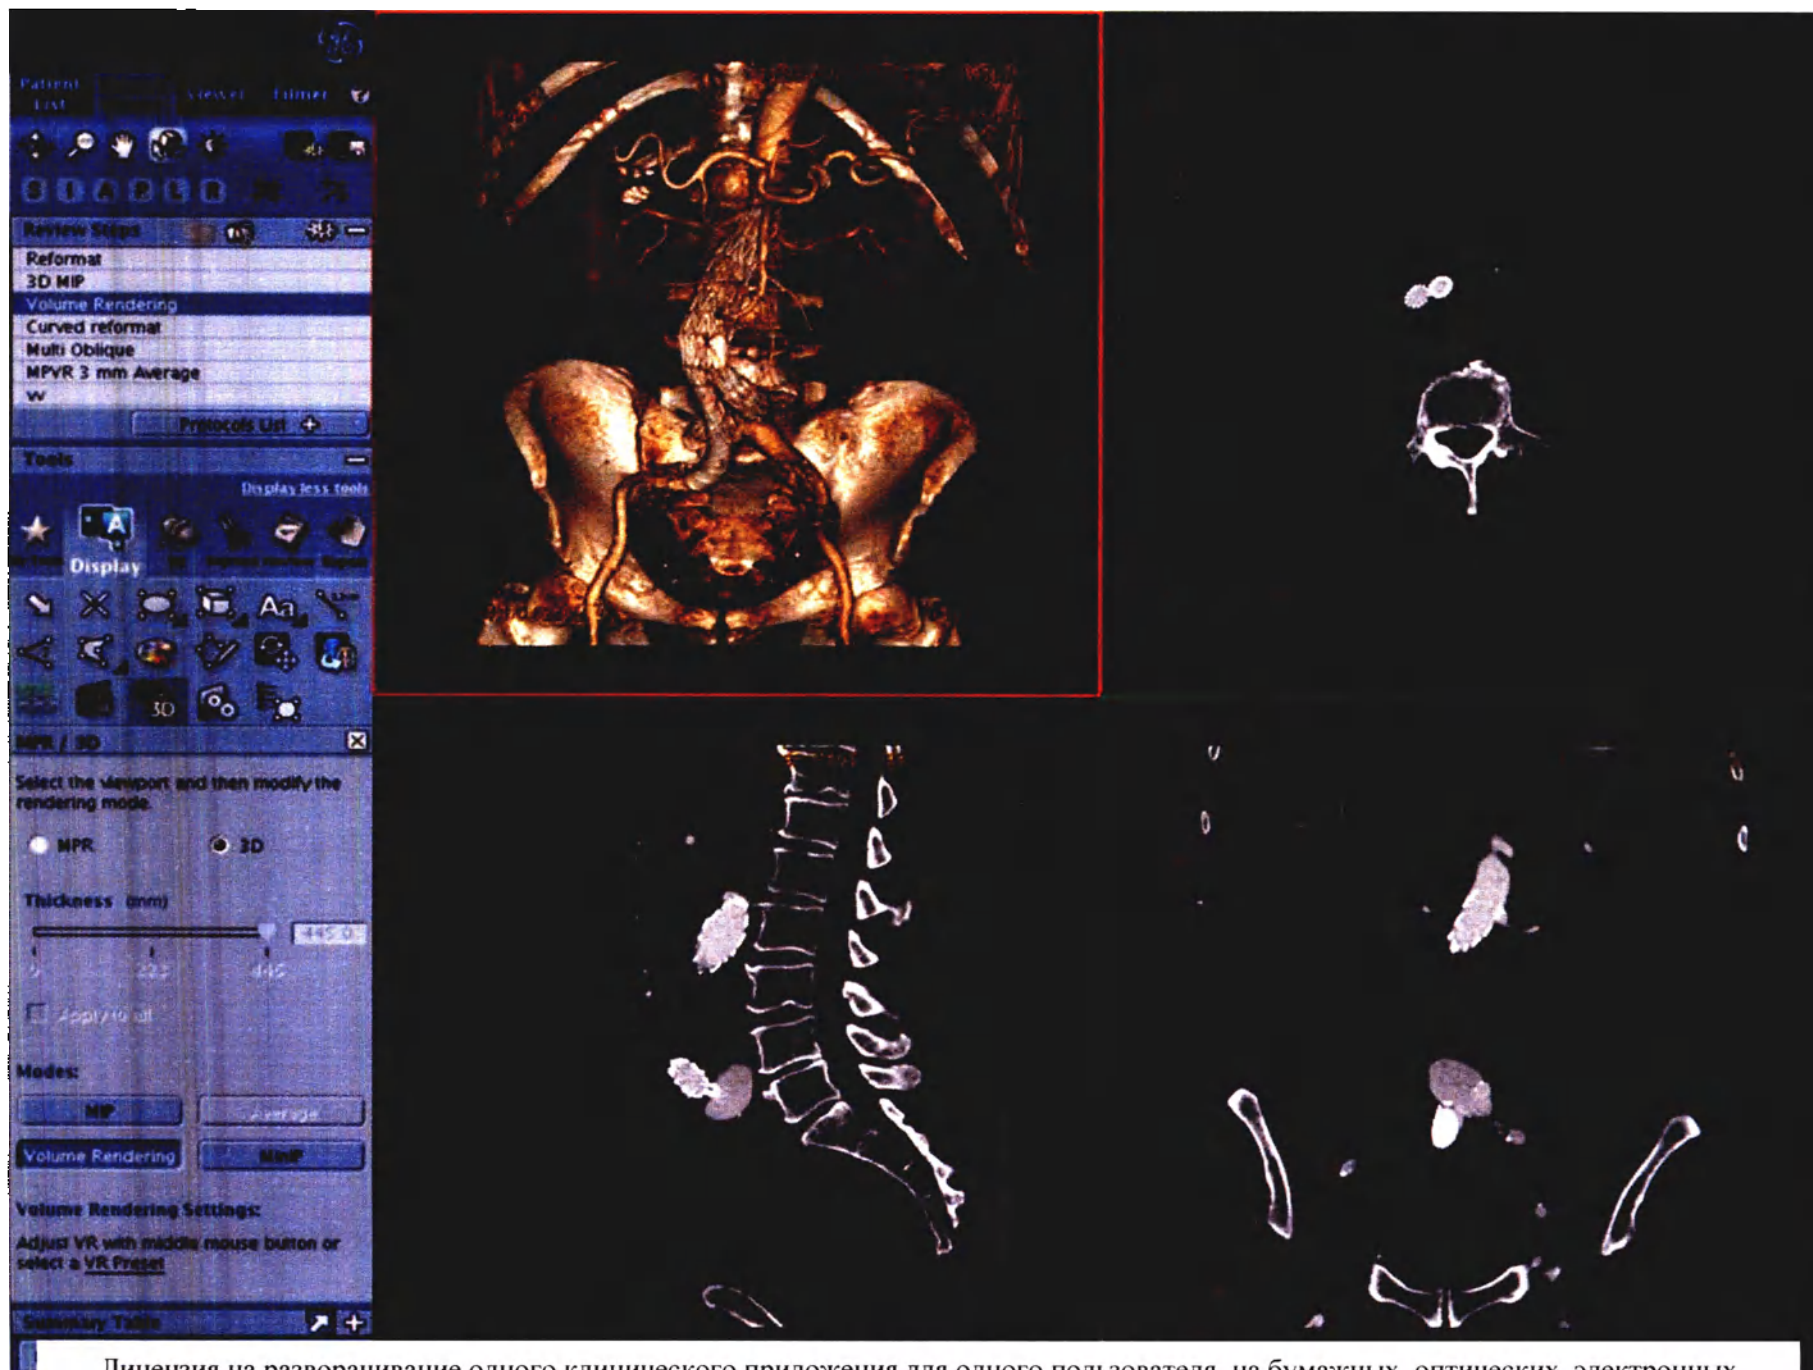

Лицензия на разворачивание одного клинического приложения для одного пользователя, на бумажных, оптических, электронных носителях, а также в электронном виде через сеть интернет.

Рисунок 134.

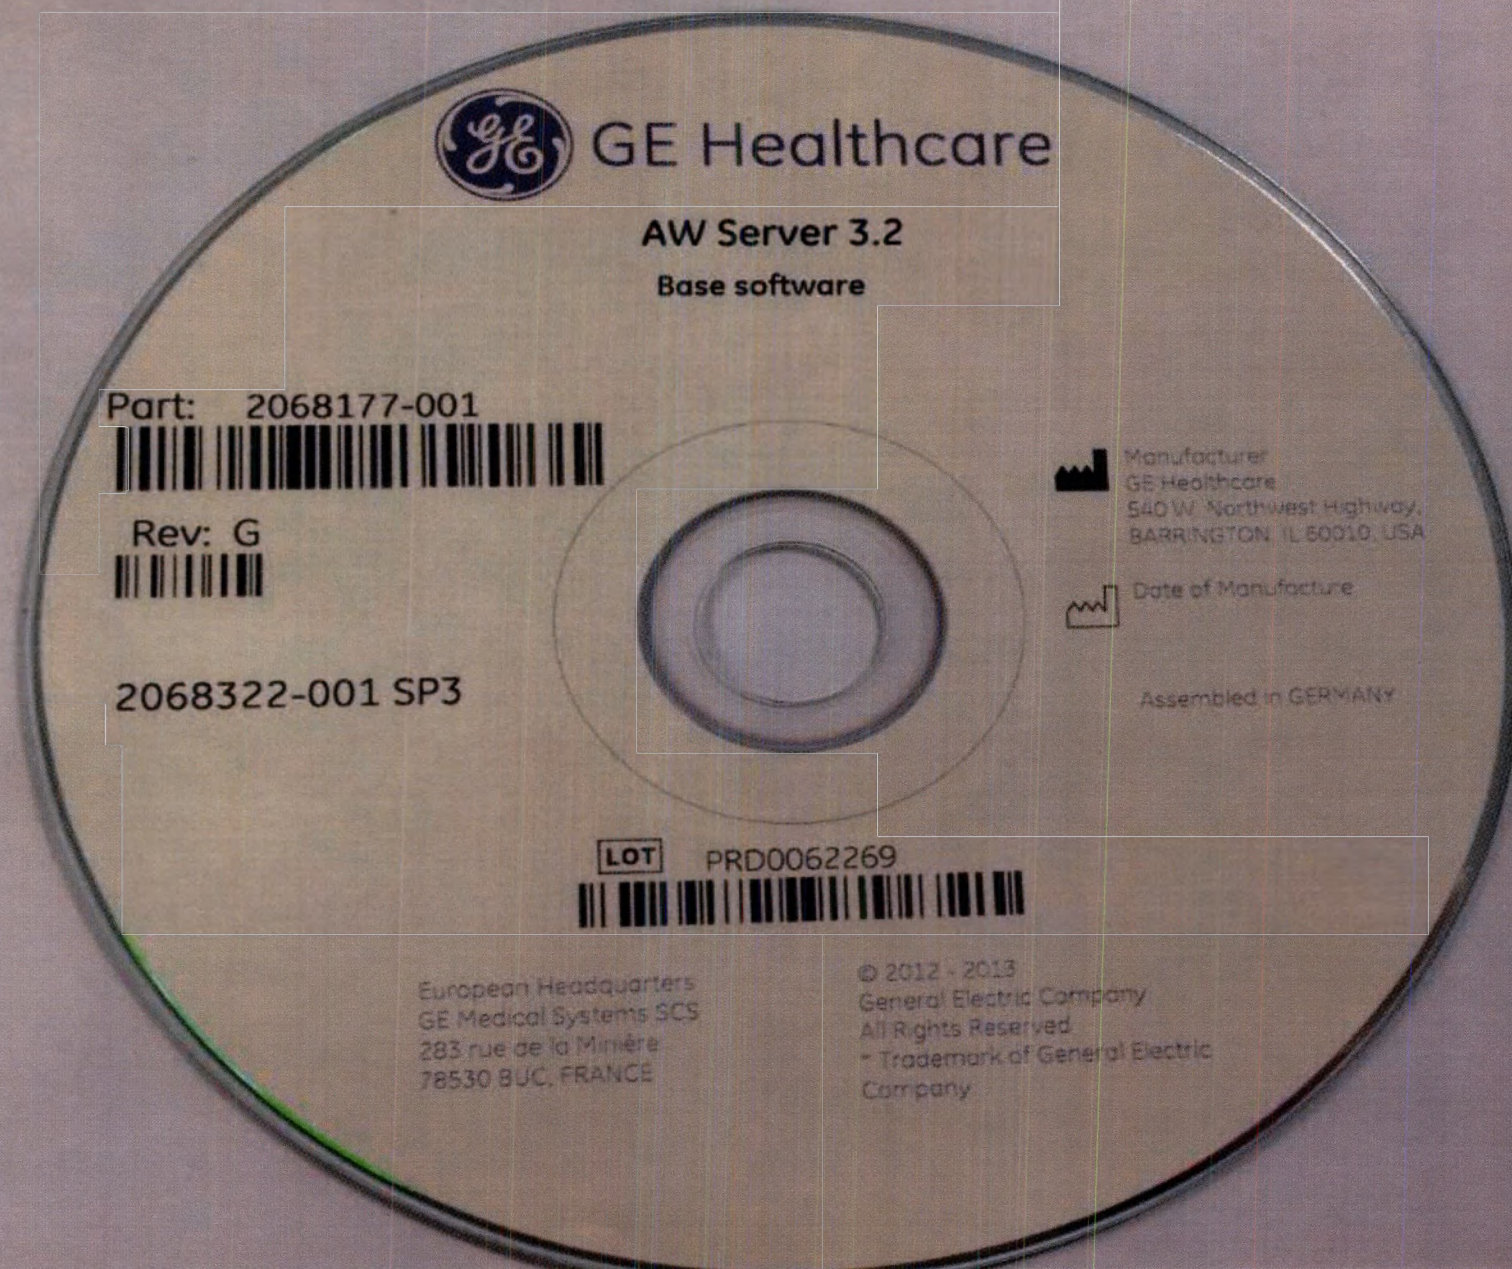

Программное обеспечение для постобработки диагностических изображений и разворачивания клинических приложений, на бумажных, оптических, электронных носителях, а также в электронном виде через сеть интернет.



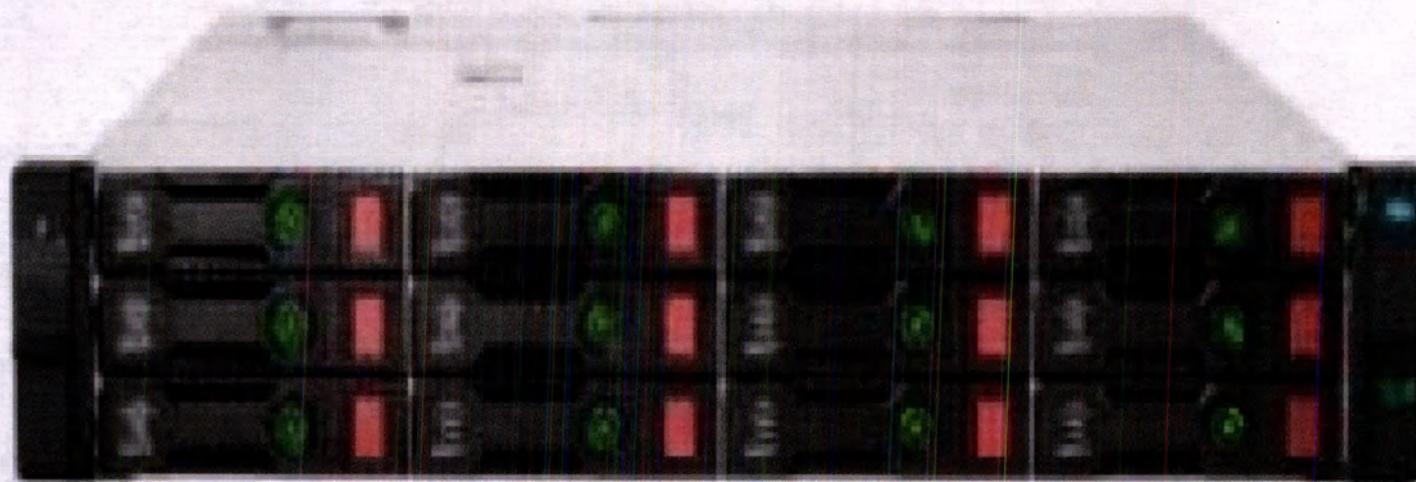


Рисунок 137. Модули хранения медицинских изображений.

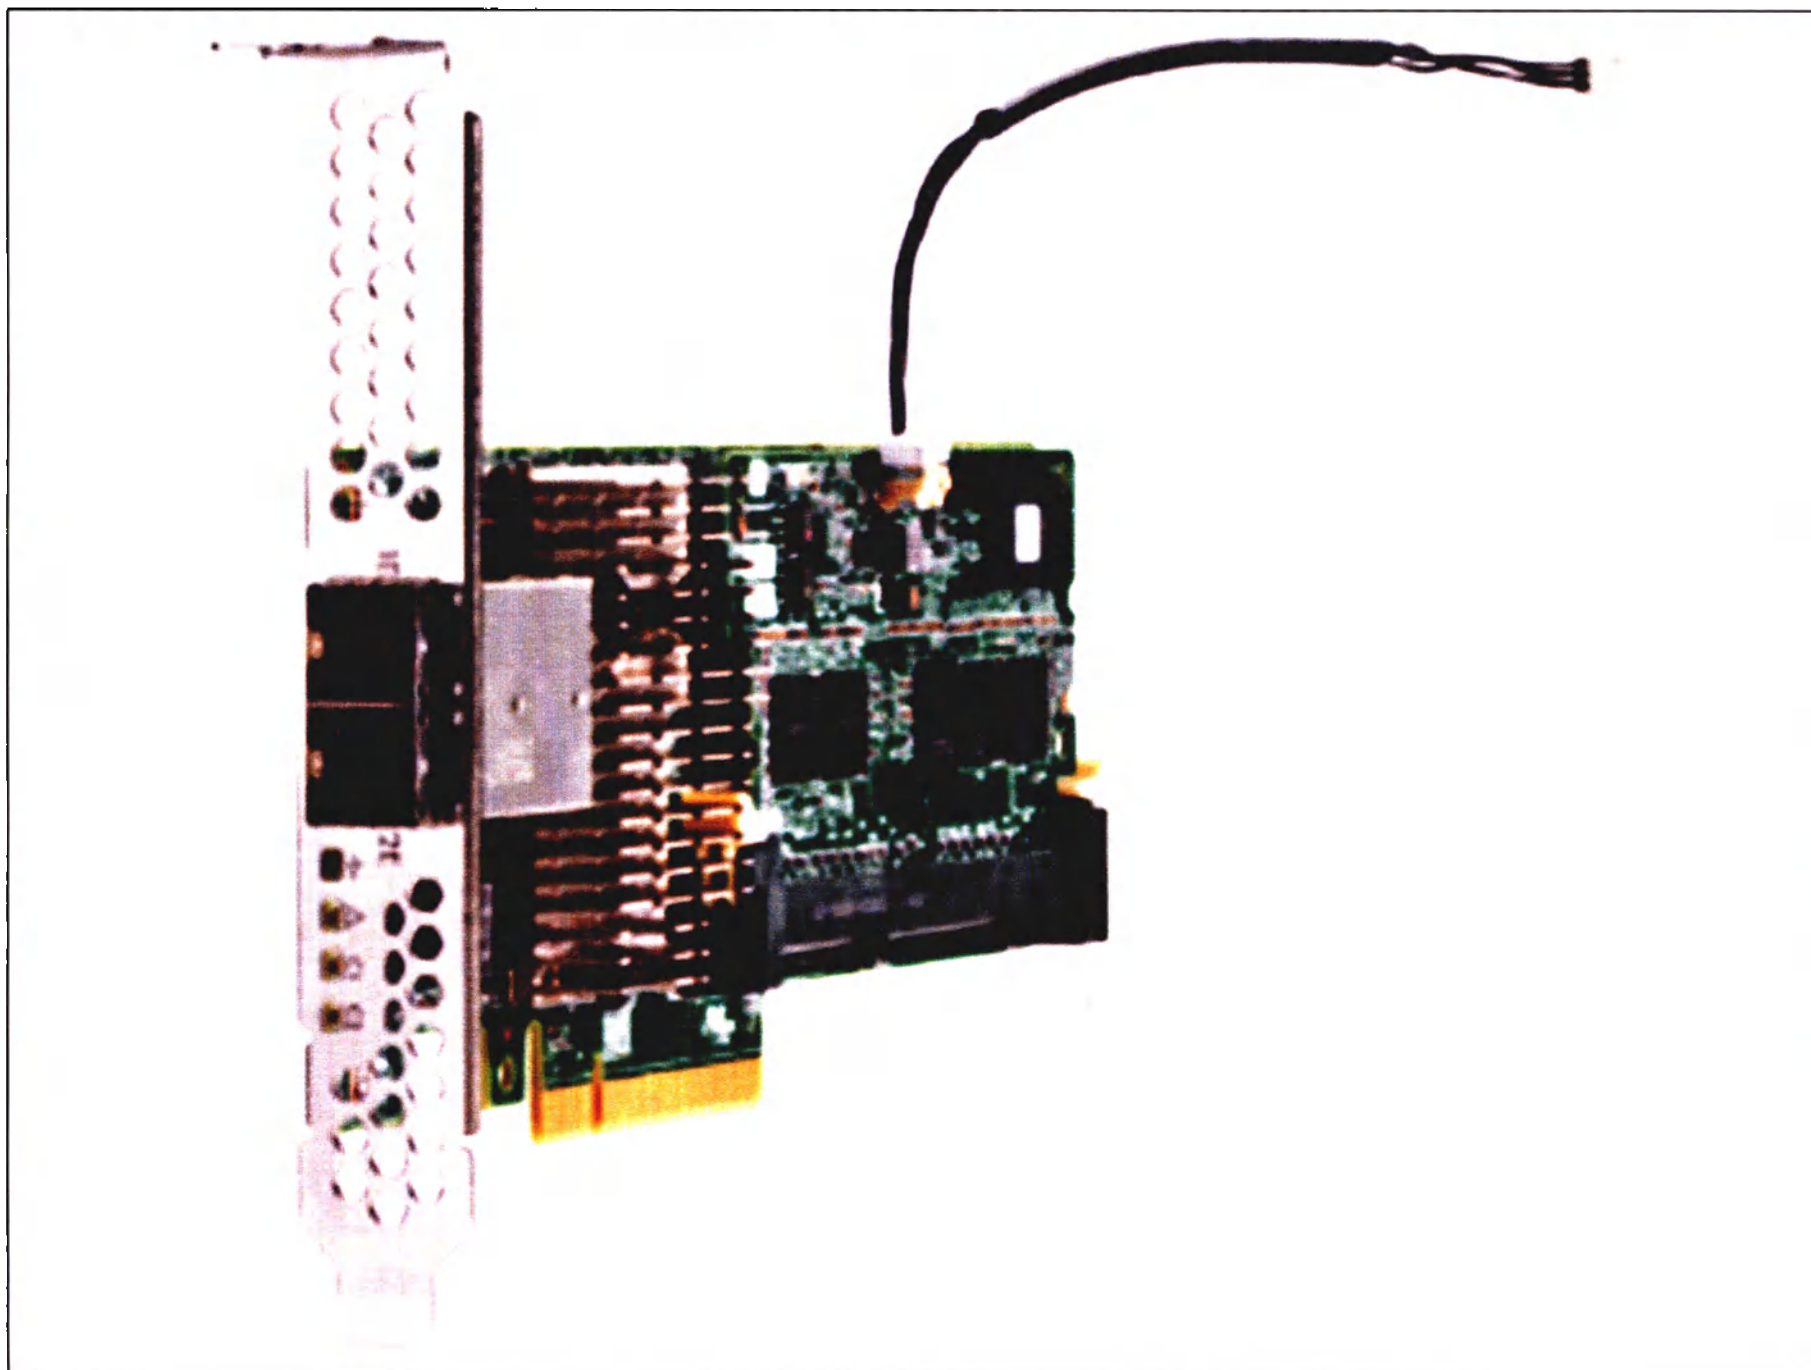


Рисунок 138. Контроллер для подключения модуля хранения к процессору.

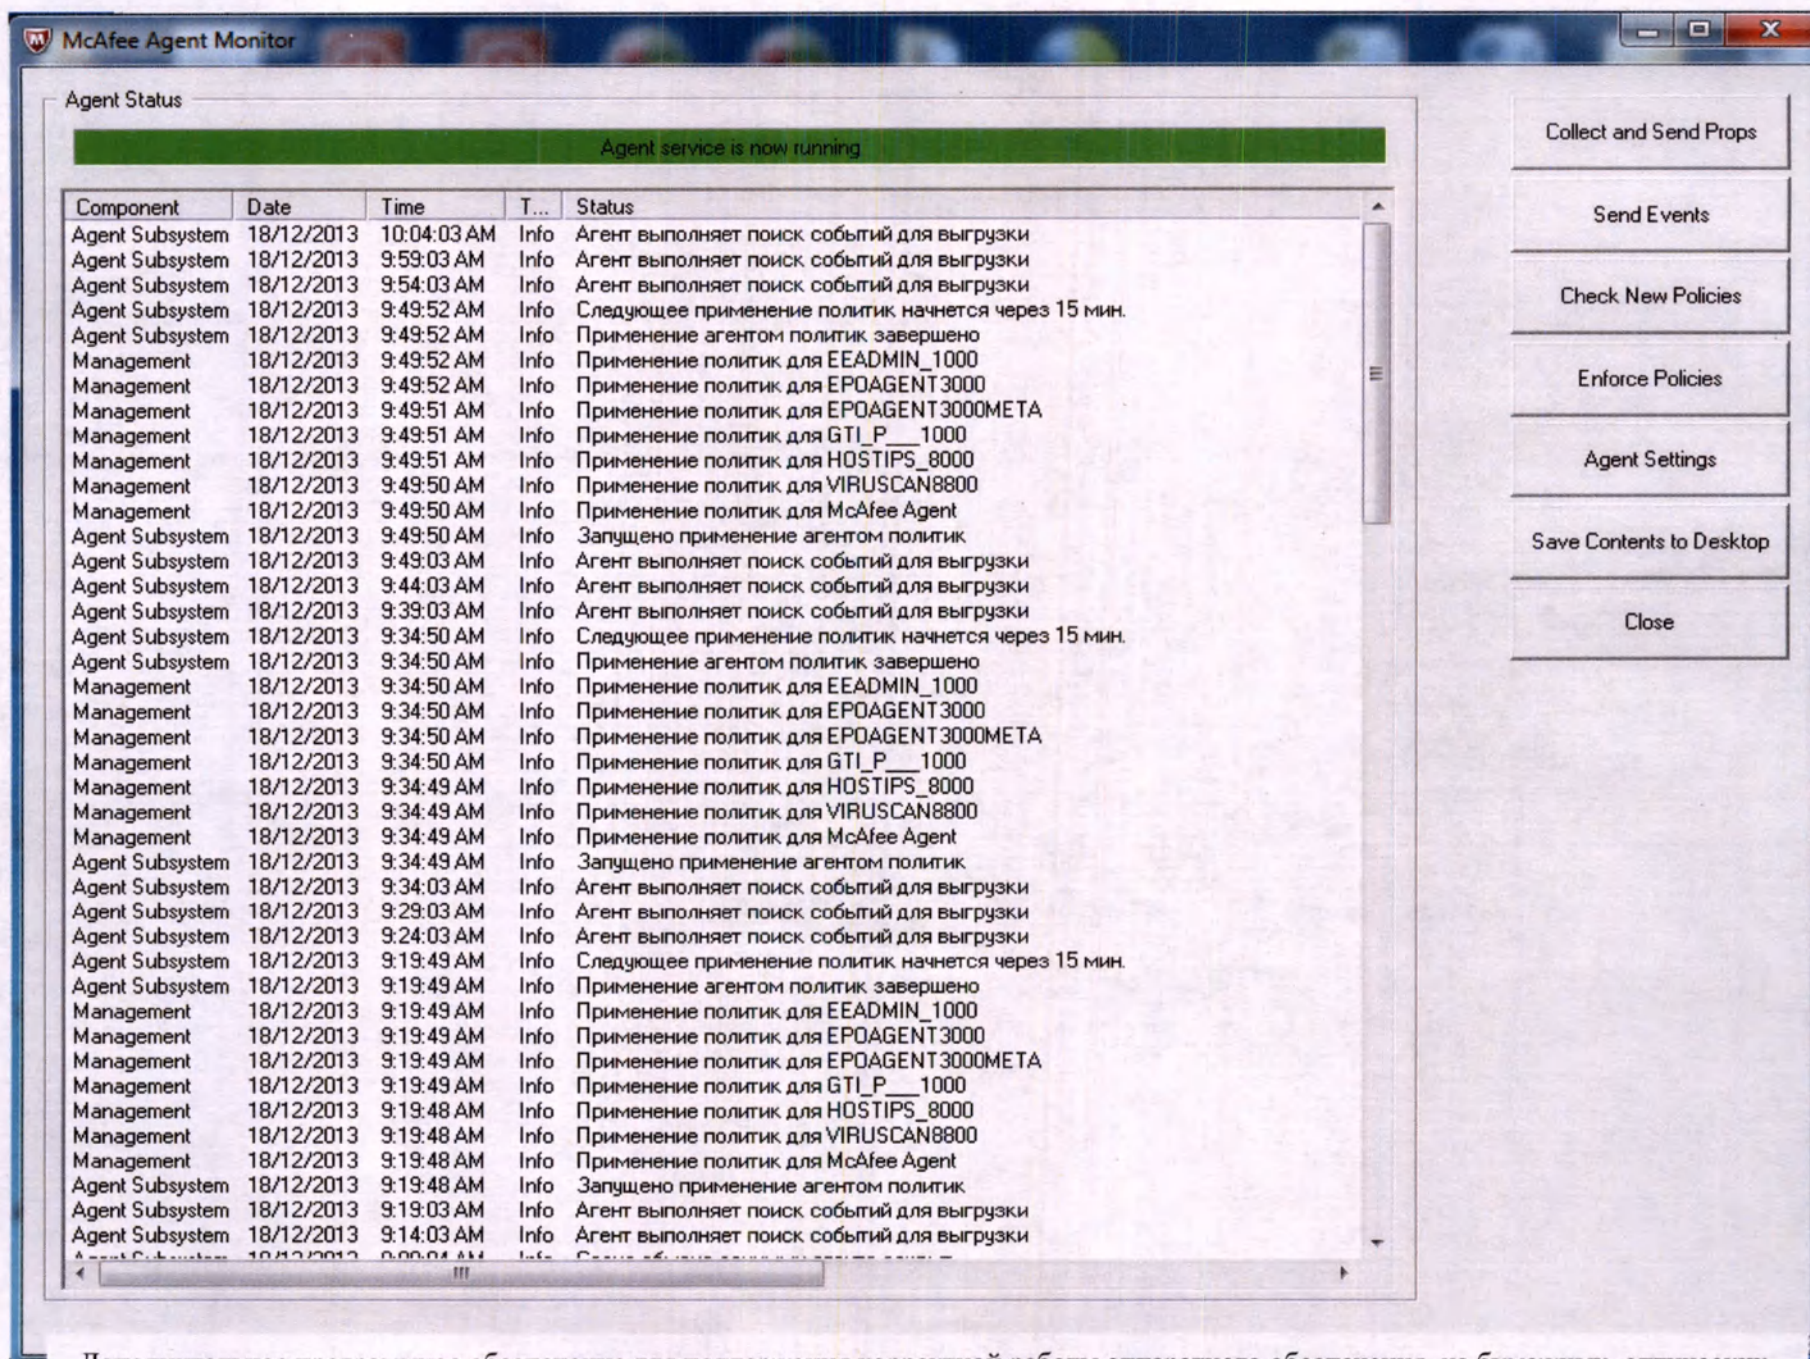


Рисунок 139.

Дополнительное программное обеспечение для поддержания корректной работы аппаратного обеспечения, на бумажных, оптических, электронных носителях, а также в электронном виде через сеть интернет.

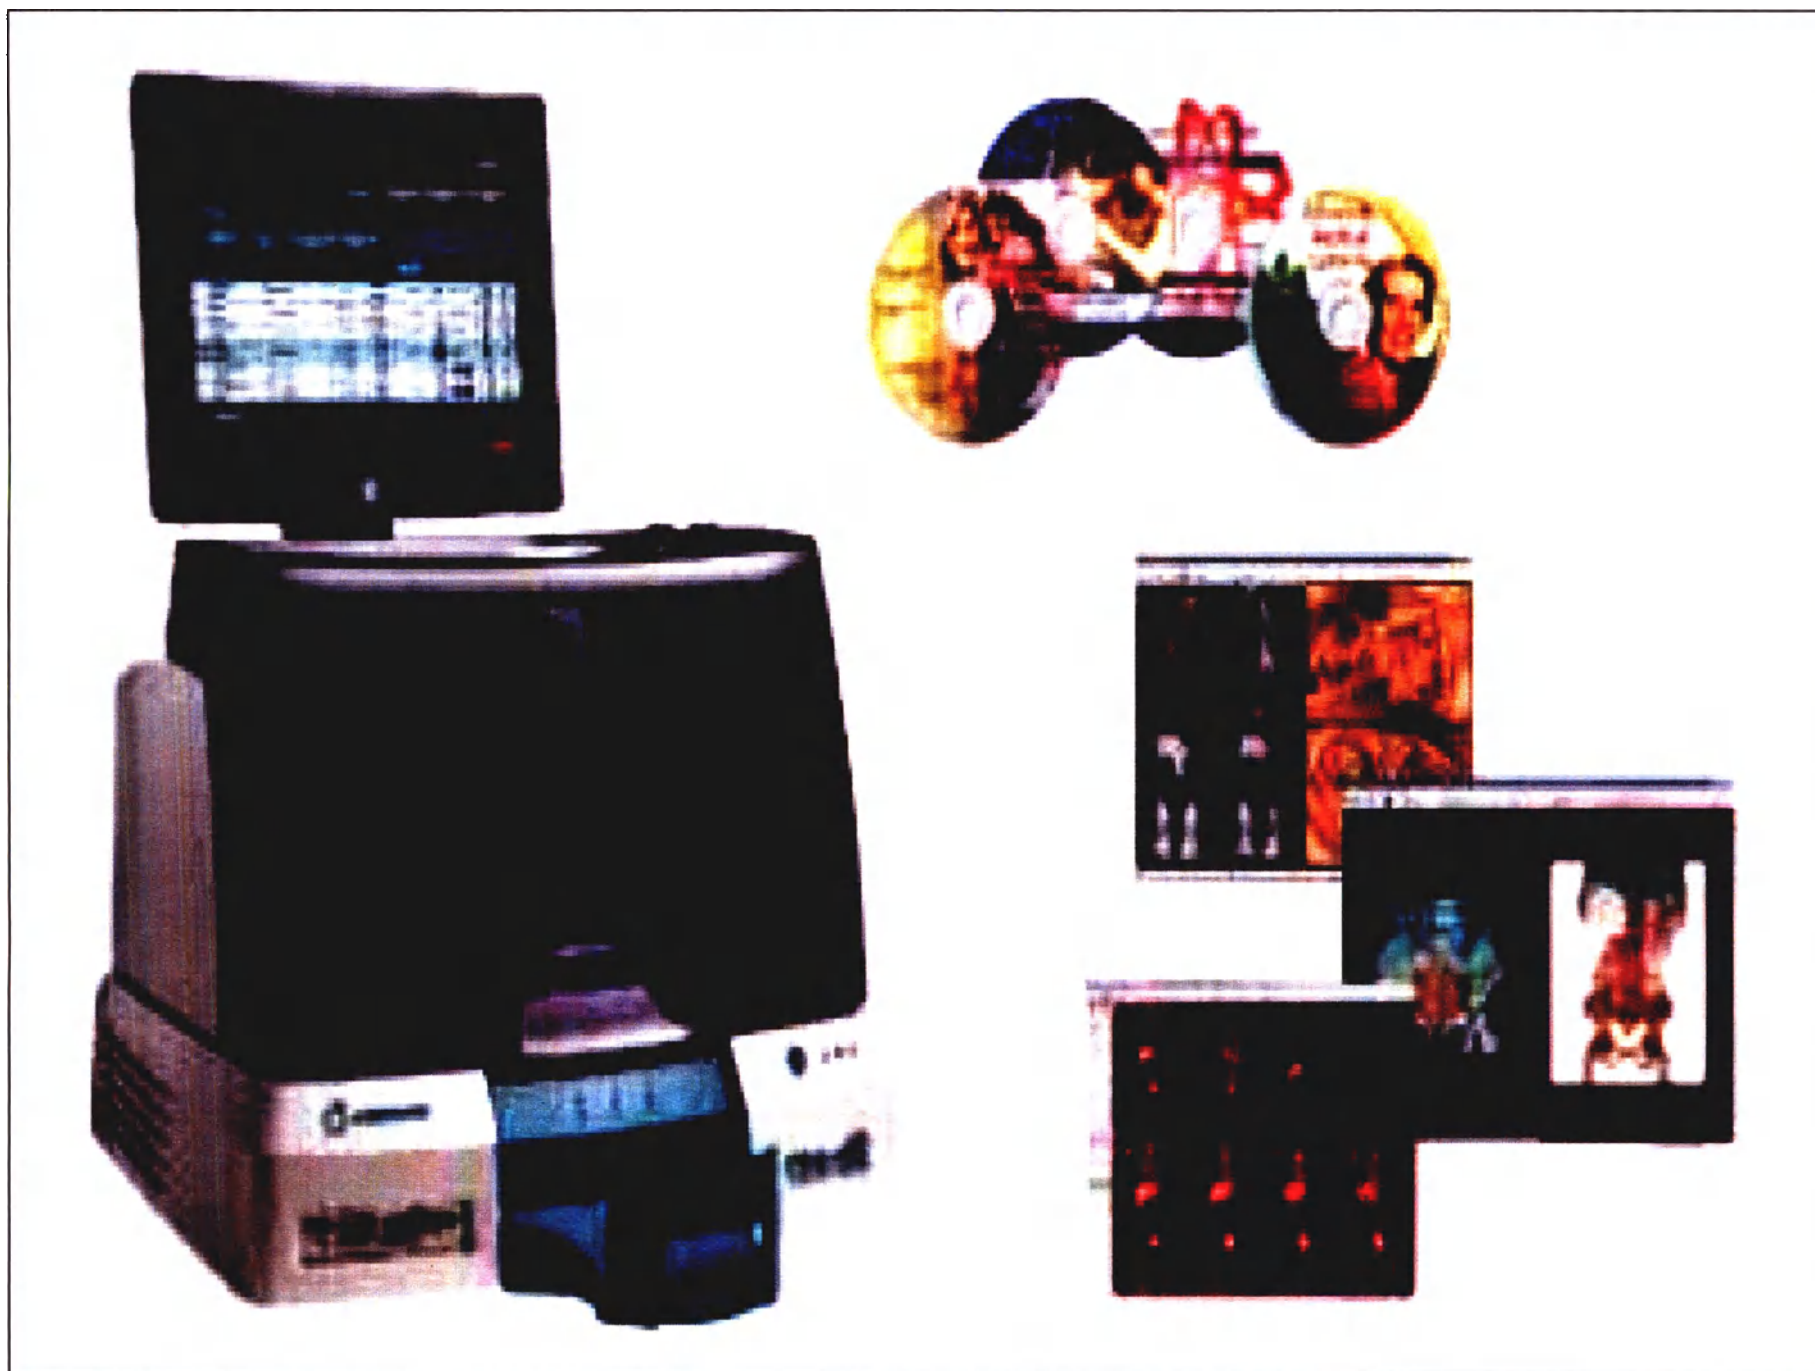


Рисунок 140. Автоматизированные станции для тиражирования CD/DVD дисков с медицинской информацией.



Рисунок 141 Стойки для размещения процессоров сбора медицинских данных. Шкаф в открытом и закрытом положении.



Рисунок 142. Дополнительные модули для хранения медицинской информации.



Рисунок 143. Баллоны и головки к автоматическому устройству для введения контрастного вещества.

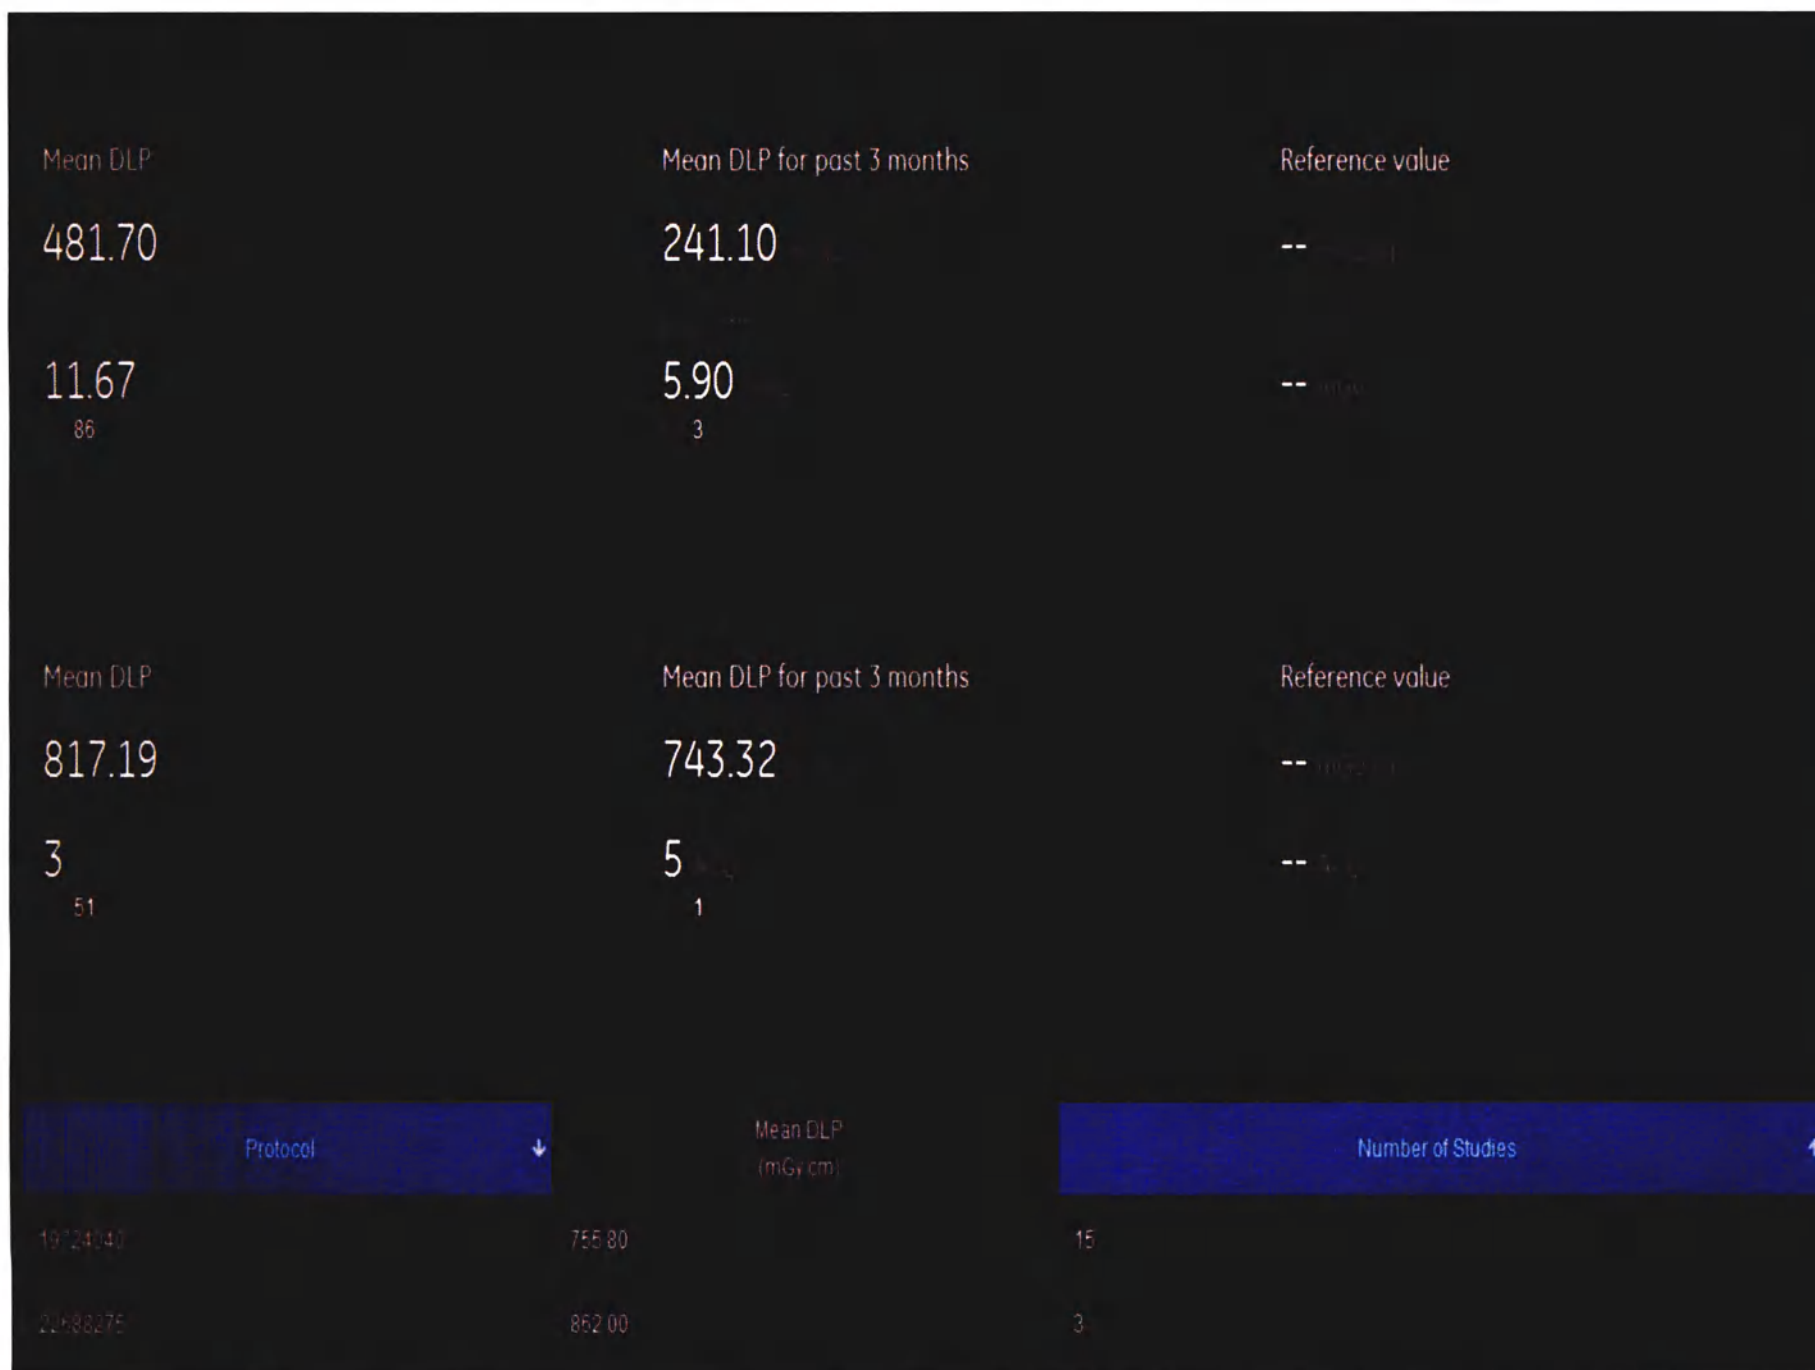


Рисунок 144. Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки DoseWatch на оптических и электронных носителях.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 74
_____ листах

