

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



 Хусаинов М.Д.


«20»  мая 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
ИЗ СЫВОРОТКИ (ПЛАЗМЫ) КРОВИ
(РеалБест экстракция 1000)

фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)»
 (серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №1
(серия 1)

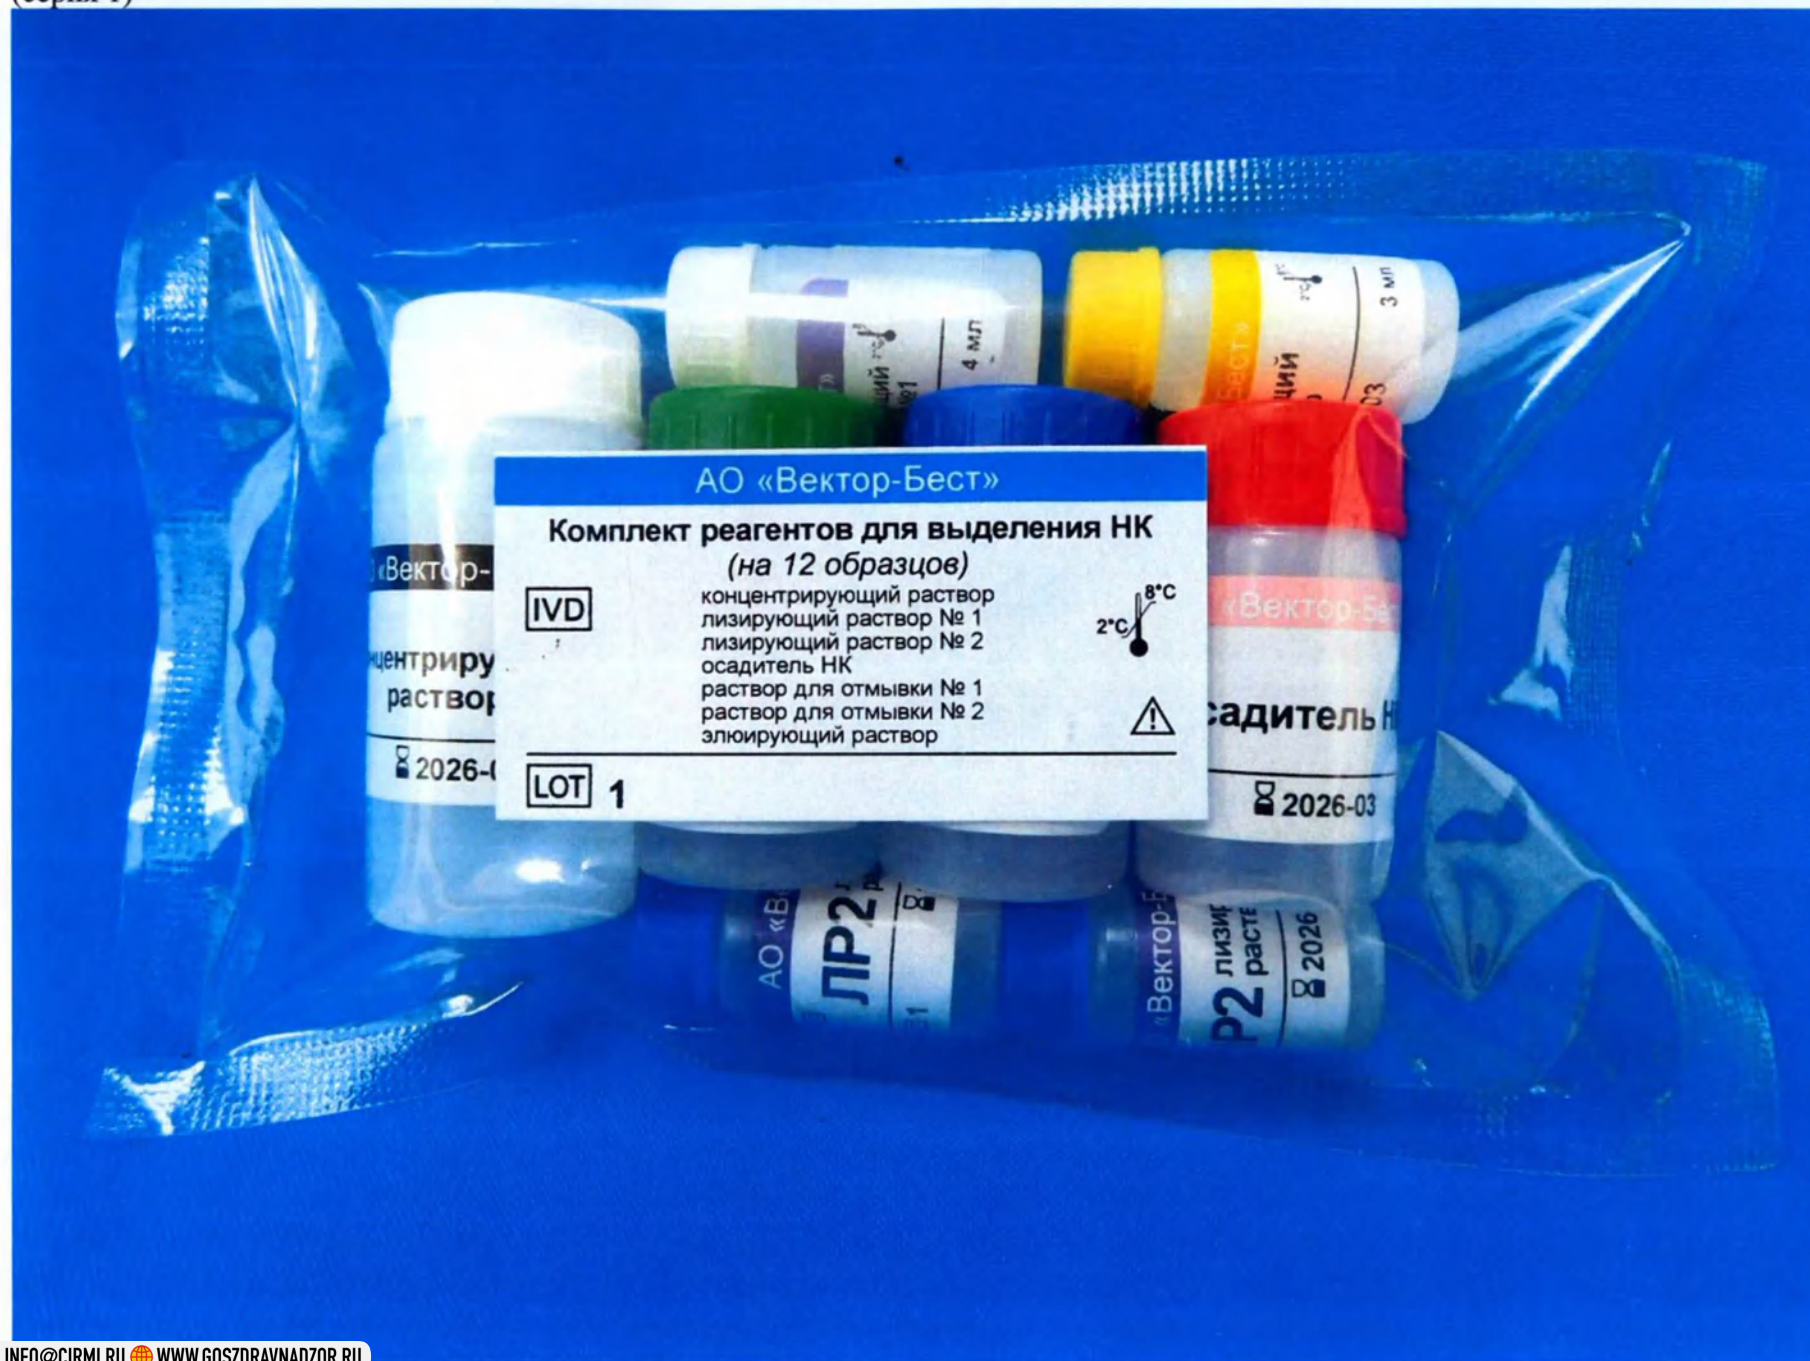



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №3
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №4
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №5
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №6
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №7
(серия 1)



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот
из сыворотки (плазмы) крови

РеалБест экстракция 1000

LOT 1

СОСТАВ:

LOT

Комплект реагентов для выделения НК:

1. Концентрирующий раствор	4 фл.	по 14 мл	1
2. Лизирующий раствор № 1 (ЛР1)	4 фл.	по 4 мл	1
3. Лизирующий раствор № 2 (ЛР2)	8 фл.	по 4 мл	1
4. Осадитель НК	4 фл.	по 12 мл	1
5. Раствор для отмывки № 1	4 фл.	по 8 мл	1
6. Раствор для отмывки № 2	4 фл.	по 5 мл	1
7. Элюирующий раствор	4 фл.	по 3 мл	1
8. Сорбент (суспензия магнитных частиц)	1 фл.	1 мл	1


Комплект контрольных образцов:

9. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)	2 фл.	по 4 мл	1
10. Внутренний контрольный образец (ВКО)	2 фл.		1
11. Отрицательный контрольный образец (ОКО)	3 фл.	по 12 мл	1
12. Пластиковые крышки	2 шт.		

ТУ 9398-210-23548172-2009

ру

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №2
(серия 1)

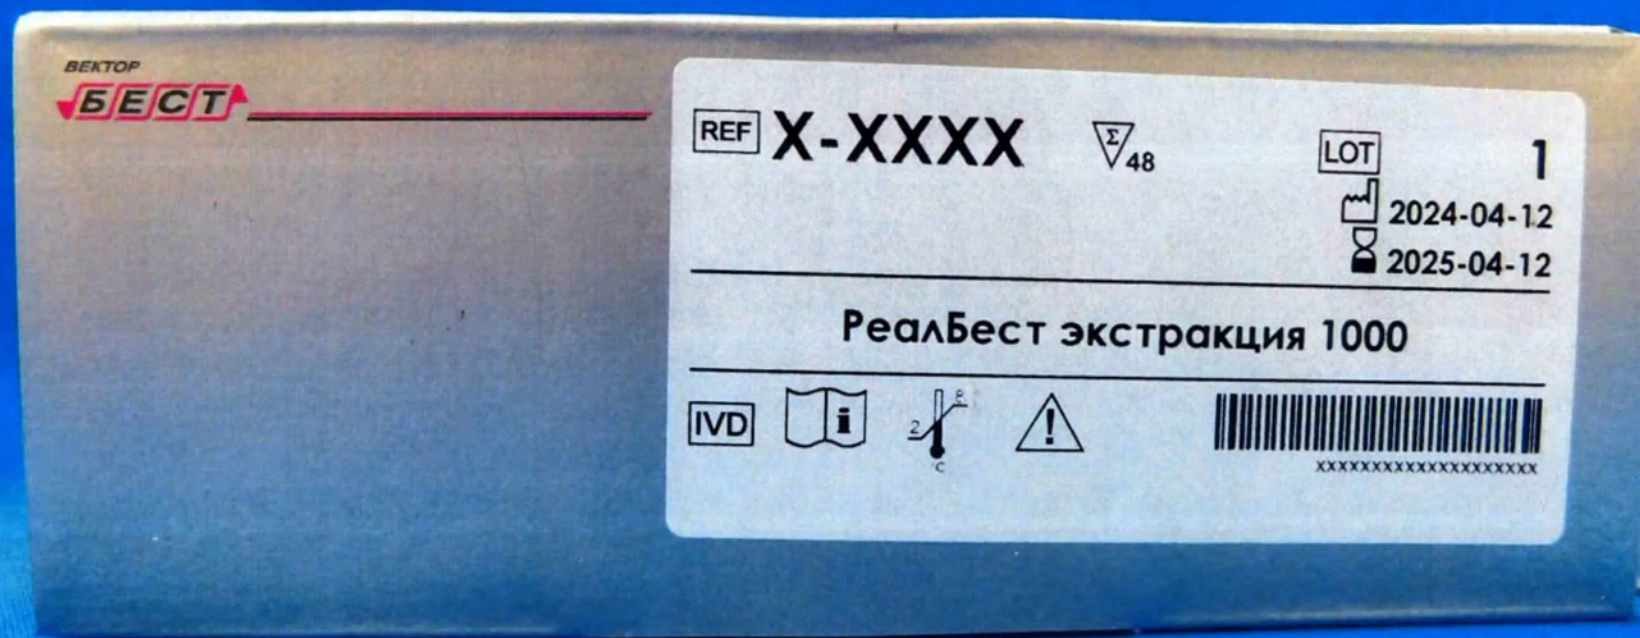

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (РеалБест экстракция 1000)» №3
(серия 1)



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В.
06 24 г.