

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Термометр «Armed»

производство: Guangzhou Bercom Medical Device Co., Ltd. («Гуанчжоу Берком Медикал Девайс Ко., Лтд.»)



Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ООО «ОПОРА»)
(наименование организации-заявителя)

I. Внешний вид изделия:

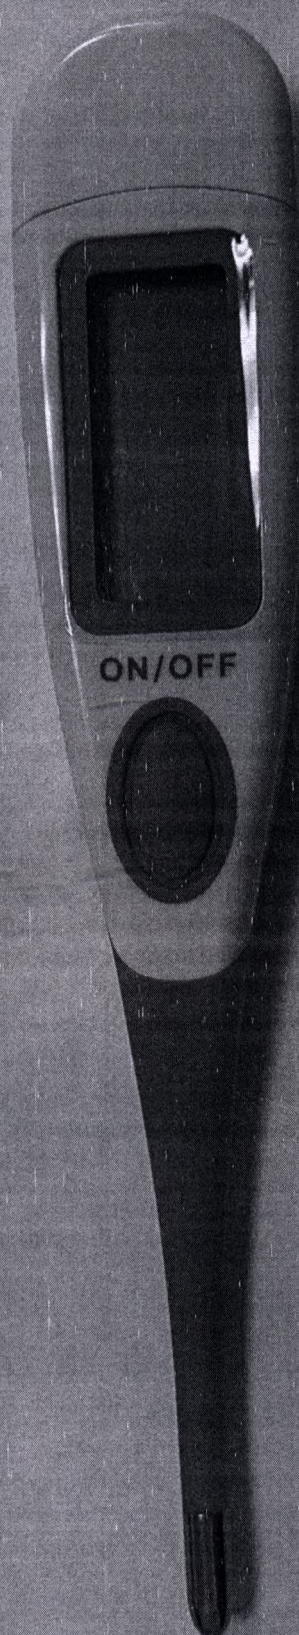


Рис. 1 – Термометр «Armed», вариант исполнения DT001

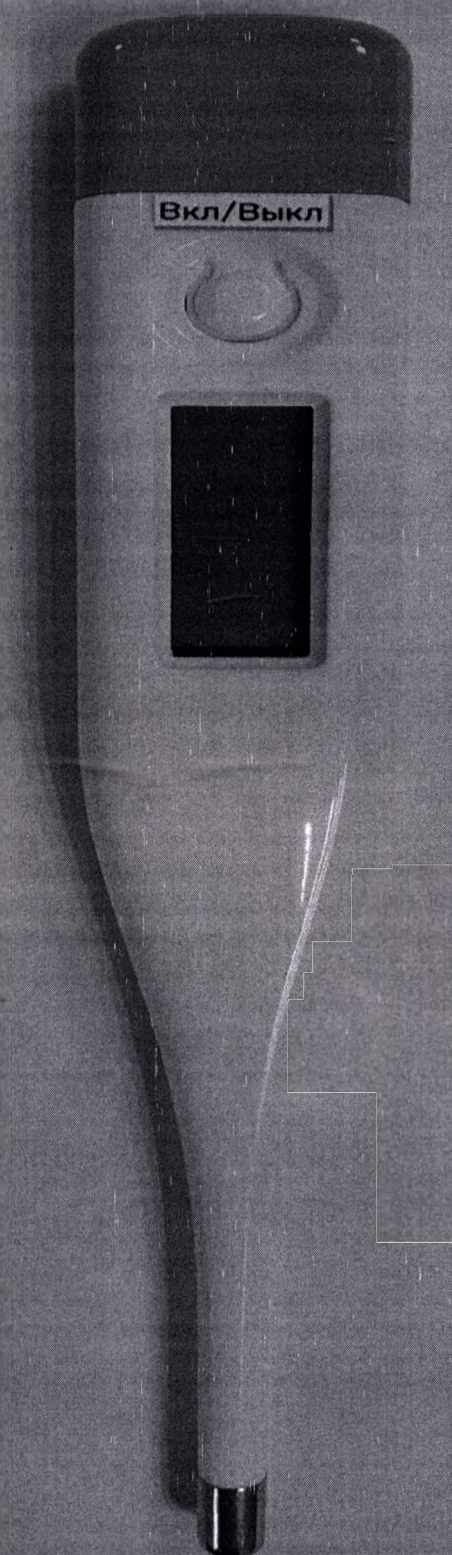


Рис. 2 – Термометр «Armed», вариант исполнения DT007

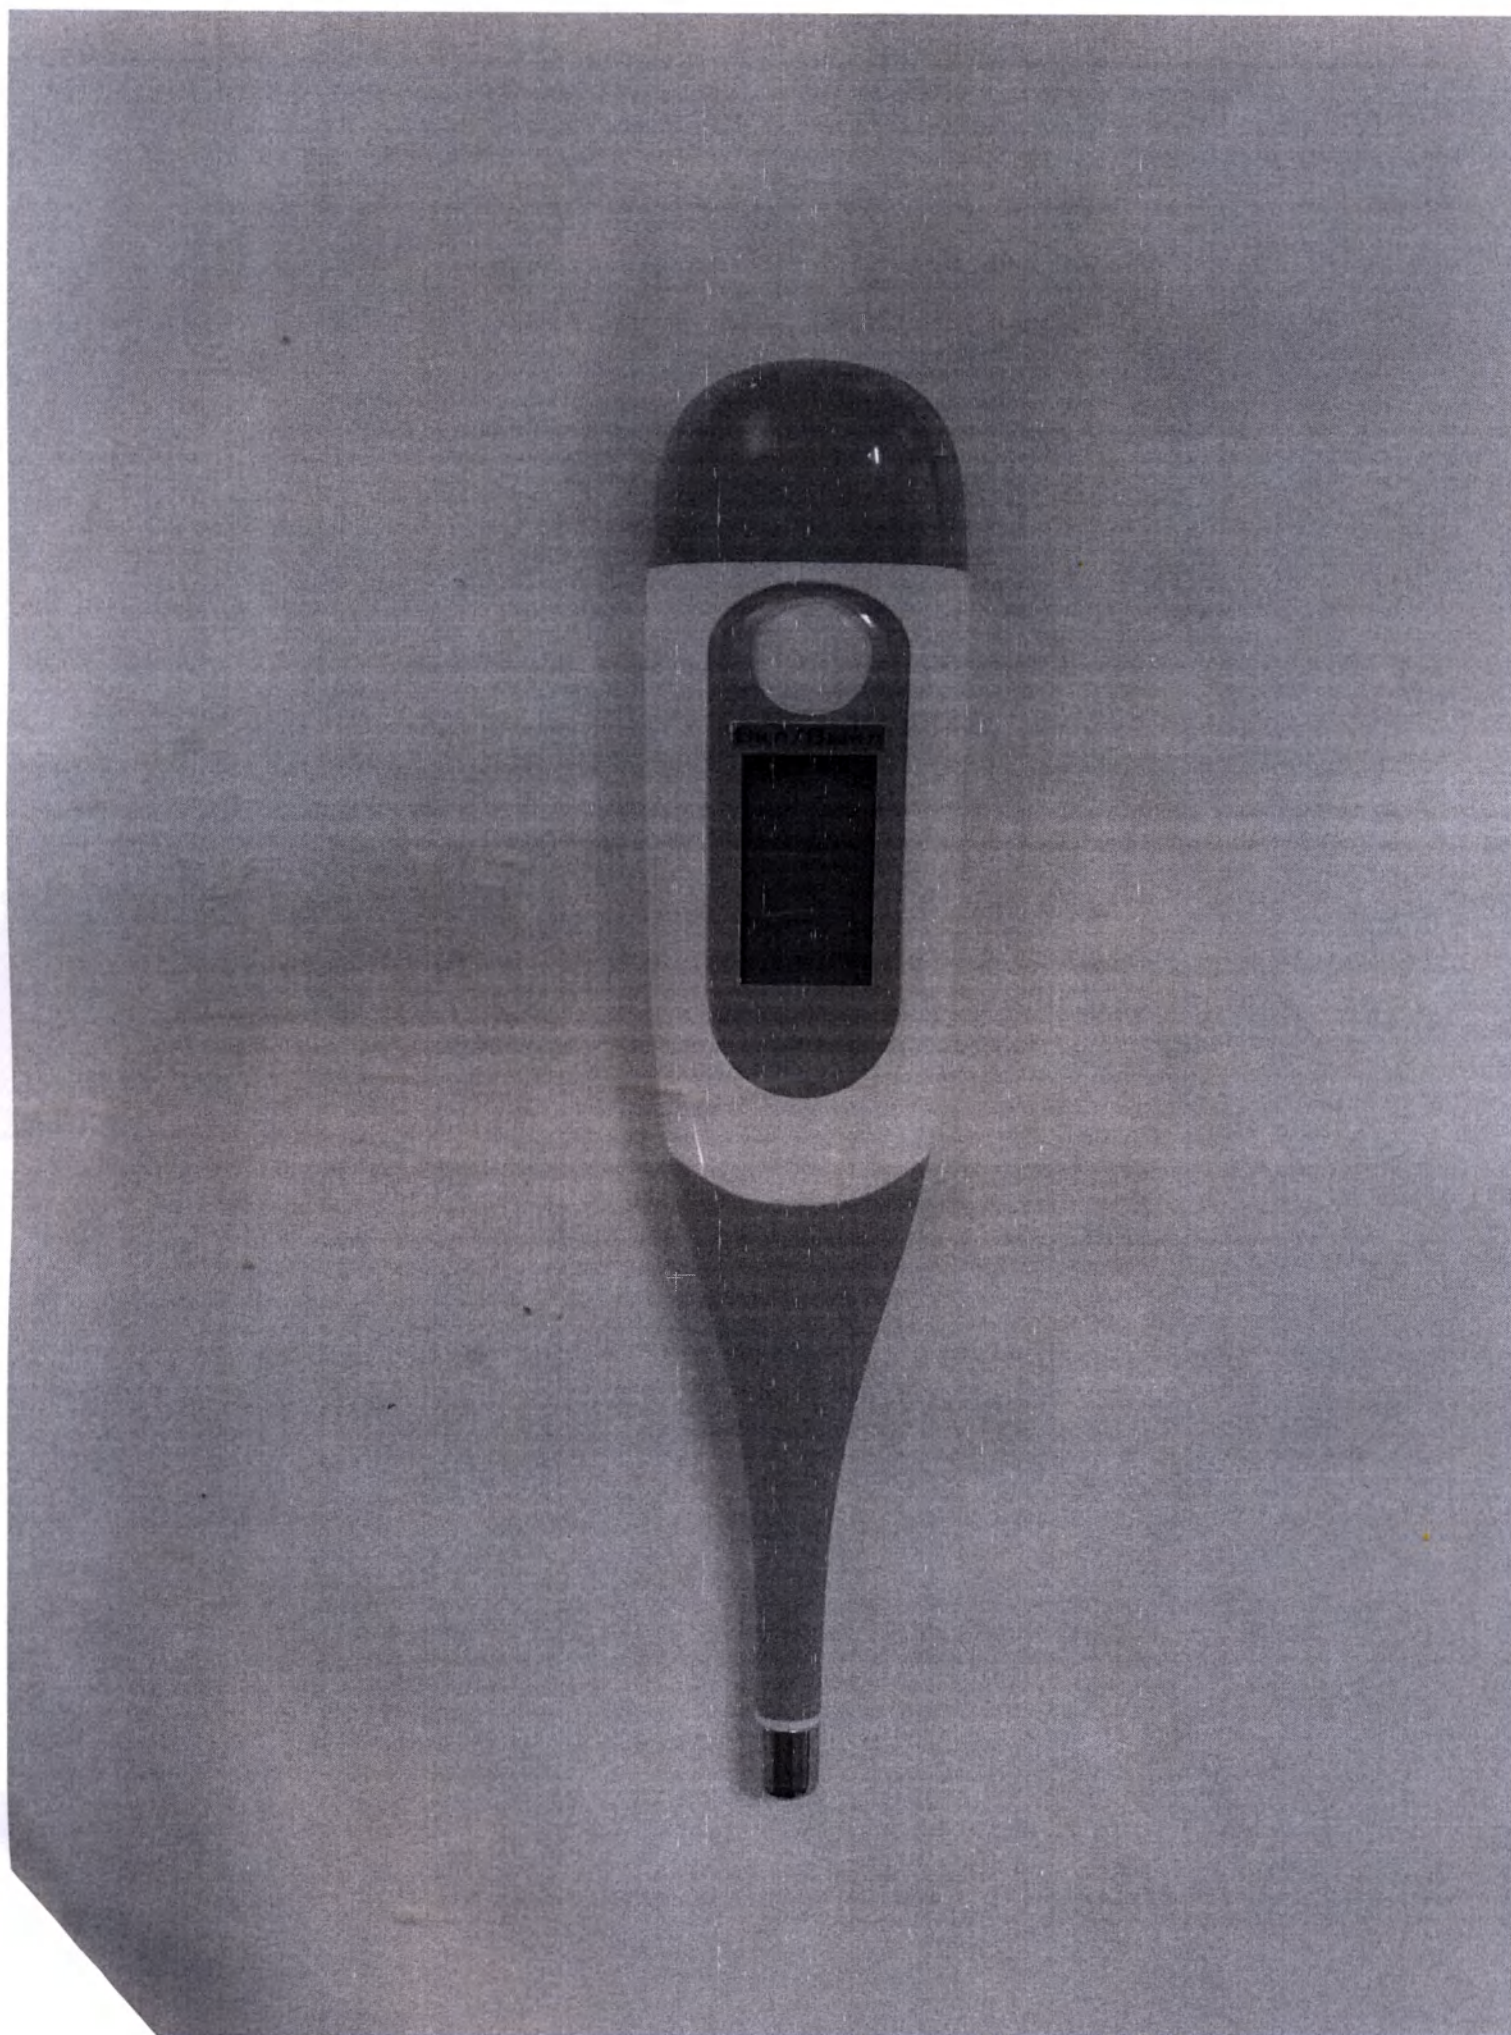


Рис. 3 – Термометр «Armed», вариант исполнения DT008



Рис. 4 – Элемент питания (для вариантов исполнения DT001, DT007, DT008)

Термометр "Armed" DT001

РУ № _____ ОТ _____


- Способ измерения: орально/аксиллярно
- Элемент питания: DC 1.5 В
- Рабочий ток: 1 мА



Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd.



IP27 



www.armed.ru

DT001 Термометр "Armed"

Произведено: Guangzhou Bertcom Medical Device Co., Ltd., No. 38 Huanzhen xi Road, Dagang Town, Nansha, 511470, Guangzhou, Guangdong, China (Гуанчжоу Беррком Медикал Девайс Ко., Лтд., № 38, западная улица Хуаньчжэнь, поселок Даган, Наньша, 511470 Гуанчжоу, Гуандун, Китай)
 Импортёр: ООО «ОПОРА», 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1
 Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.
 Предназначен для измерения температуры тела человека в стационарных и домашних условиях.



www.armed.ru

DT001 Термометр "Armed"



Гарантийный срок хранения: 24 месяца.
 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
 Срок службы термометра: не менее 5 лет.
 Срок службы элемента питания: более 1000 измерений.
 Дата упаковывания: _____



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью **7**

симв) лист **06**



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.