



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюнь Вэй.
«17» июня 2024 г.

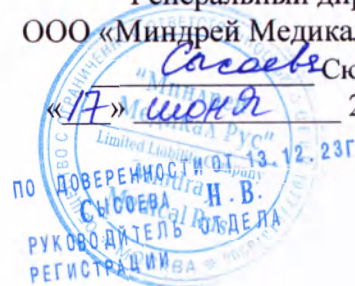

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Анализатор автоматический осадка мочи ЕН-2090, в вариантах исполнения

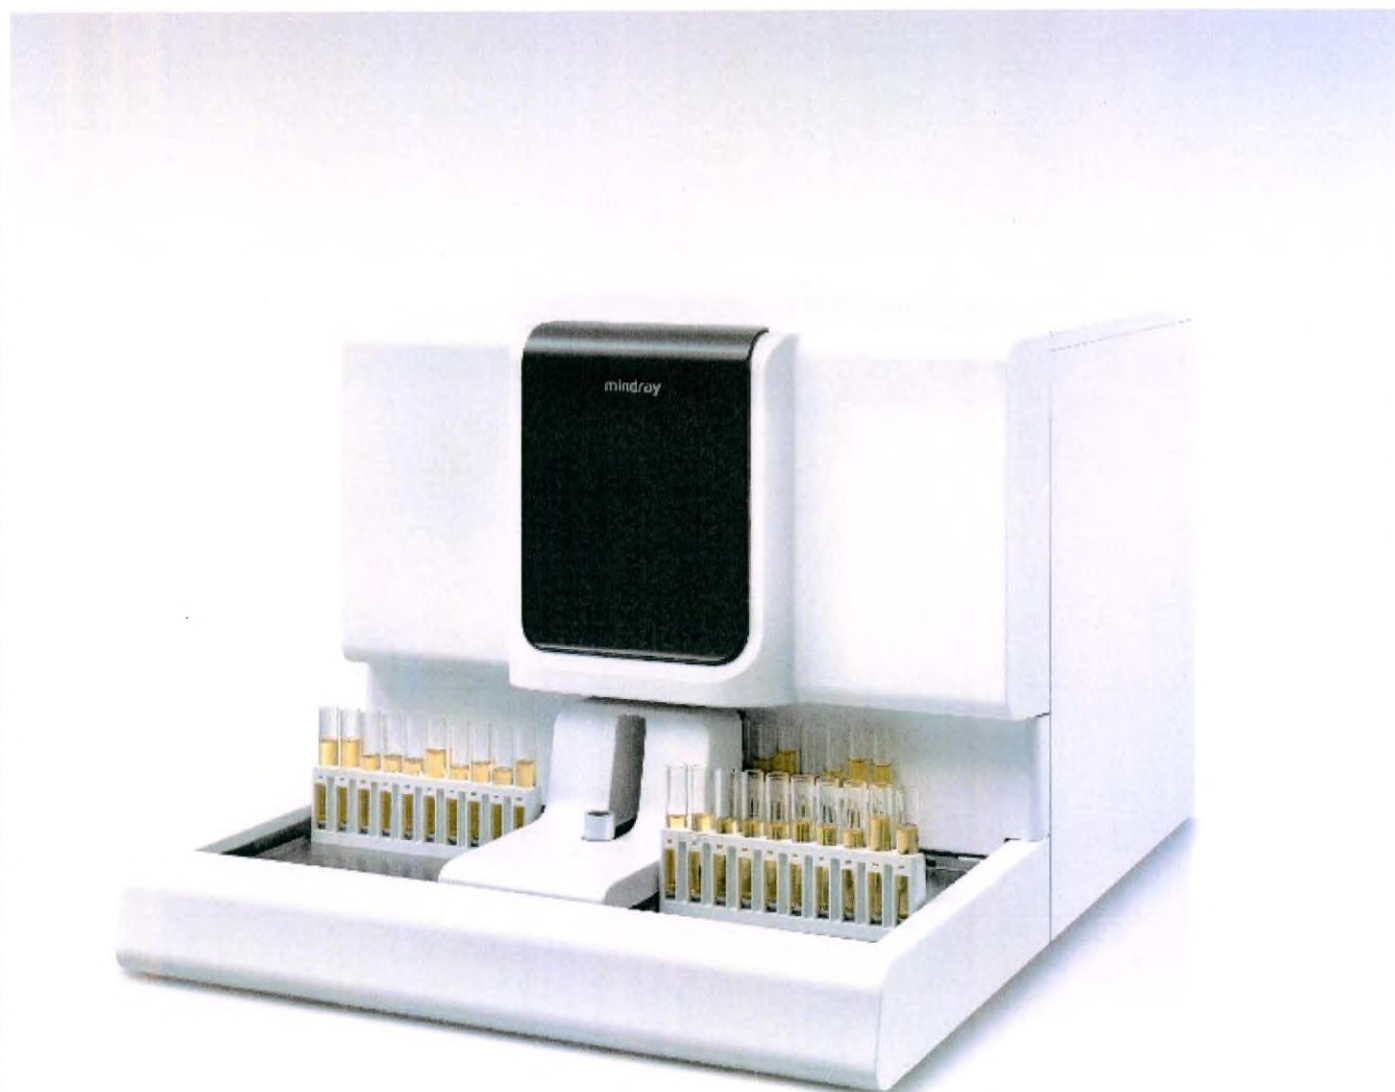

1. Анализатор автоматический осадка мочи EH-2090B – 1 шт. или Анализатор автоматический осадка мочи EH-2090C



EH-2090B/EH-2090C/EH-2090B Pro/
EH-2090C Pro


Urine Formed Element Analyzer

Operator's Manual

mindray

mindray

Urine Sediment Atlas

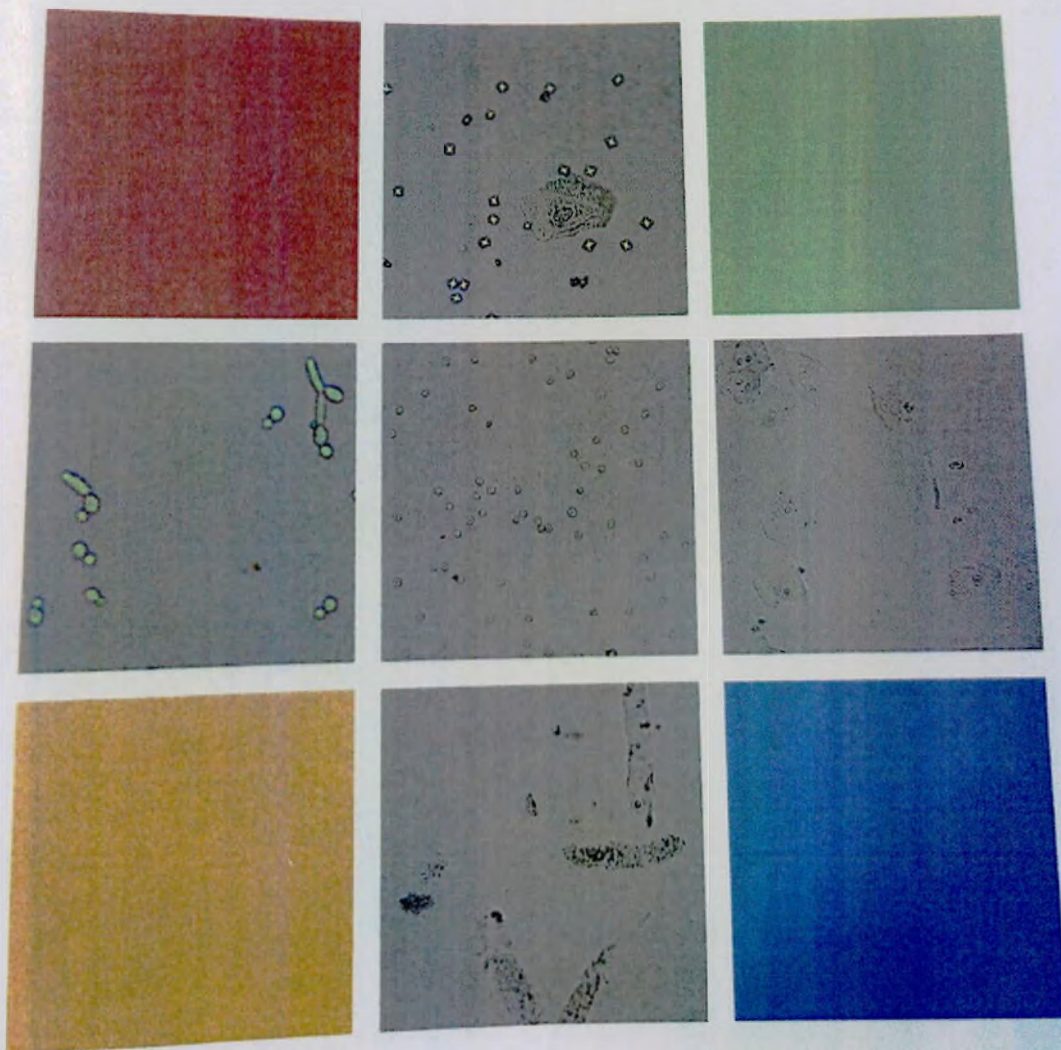

4. Кабель для подключения к источнику питания – 1 шт.;



5. Модуль автоматической загрузки проб мочи – 1 шт.;



6. Линия автозагрузчика – не более 2 шт.;



7. Передняя накладка – 1 шт.;



8. Крепежи L-образные – не более 2 шт.



9. Трубка для сброса отходов – 1 шт.;



10. Компонент крышки для промывочной жидкости – 1 шт.;



11. Программное обеспечение на USB-носителе – 1 шт.;



12. Винт для крепления к поддону – не более 6 шт.;



13. Кабель соединительный – 1 шт. (при необходимости);



14. Кабель соединительный USB – 1 шт. (при необходимости);



15. Сканер штрих-кодов внешний – 1 шт. (при необходимости), в составе:

15.1. Сканер штрих-кодов - 1 шт.;

15.2. Кабель сканера штрих-кодов – 1 шт.;



16. Набор последовательного подключения – 1 шт. (при необходимости), в составе:
- 16.1. Кабель для последовательного подключения на 4 порта – 1 шт.;
 - 16.2. Плата для последовательного подключения – 1 шт.;
 - 16.3. Кронштейн – 1 шт.;
 - 16.4. Винт – 8 шт.;
 - 16.5. Драйвер на CD носителе – 1 шт.;



17. Пробирки для анализа мочи для стартового запуска – не более 50 шт. (при необходимости);



18. Крепежный кронштейн для USB – 1 шт. (при необходимости);



19. Бутыль для жидких отходов, 5 литров – 1 шт. (при необходимости);




20. Коробка для отходов – 1 шт. (при необходимости);



21. Заглушки для винтов – 1 уп. (12 шт. / уп.) (при необходимости);



22. Штатив для пробирок с мочой – 10 шт. (при необходимости);

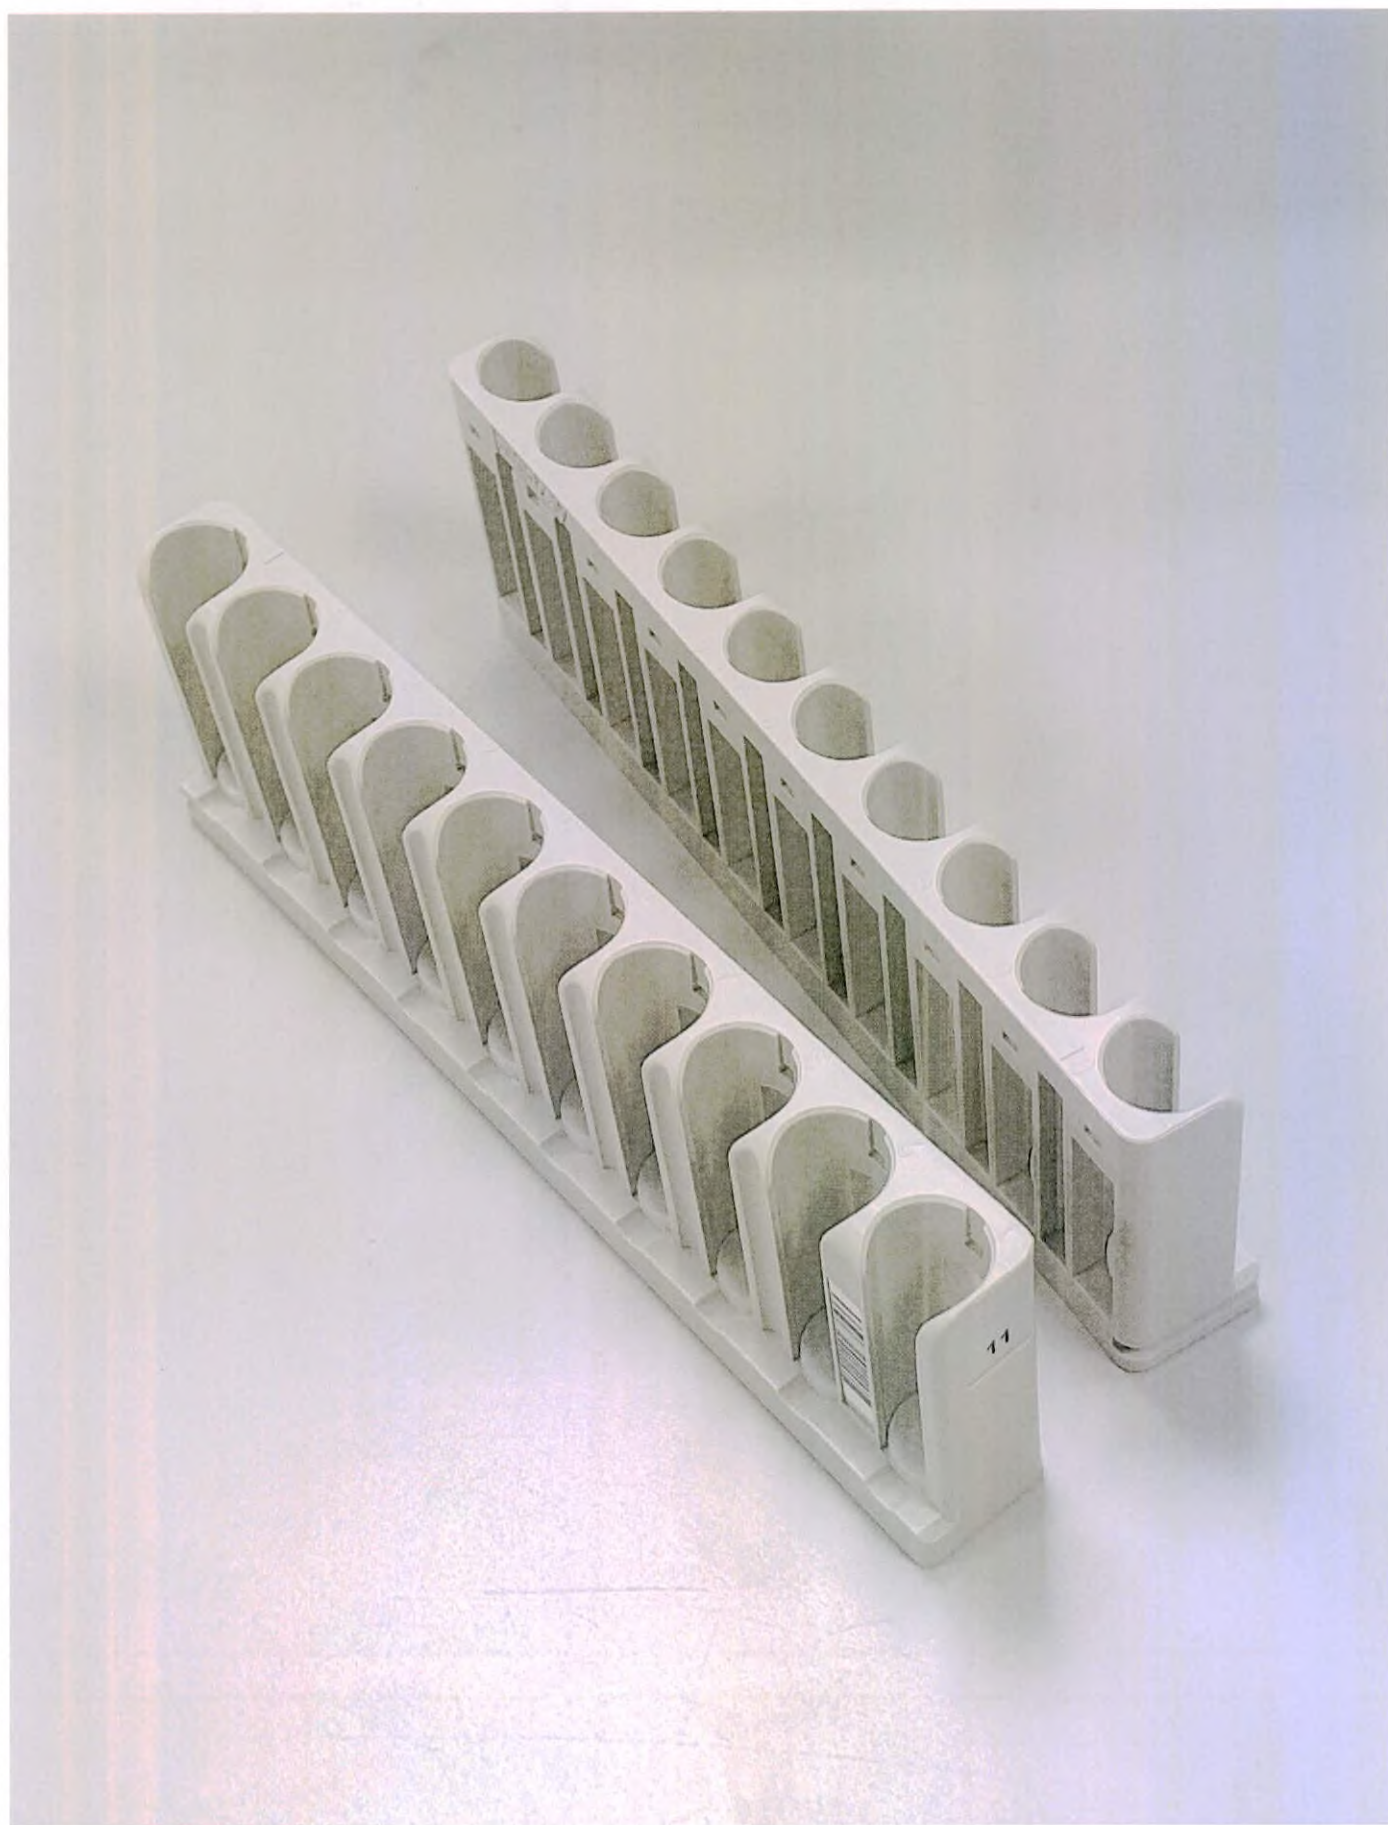

23. Держатель для пробирок желтый – не более 2 уп. (50 шт. / уп.) (при необходимости);



24. Адаптер для пробирок – 1 уп. (100 шт. / уп.) (при необходимости);



Urine Formed Element Analyzer

mindray

Model: XXXXXXXX

SN



00000000



XXXXXXXX

100-240V ~ 50/60Hz 300VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



XXXXXXXX 047-046266-00(1.0)

UDI



(01)00000000000000

(11)XXXXXX

(21)00000000



IVD

Макеты дополнительной маркировки для Российской Федерации

Анализатор автоматический осадка мочи ЕН-2090В

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;

Код серии/партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Уполномоченный представитель в РФ:

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной

Анализатор автоматический осадка мочи ЕН-2090С

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;

Код серии/партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Уполномоченный представитель в РФ:

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной

Сысоев

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23г

СЫСОВЕВ Н.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

РЕГИСТРАЦИИ

