



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 октября 2024 года № РЗН 2024/23788

На медицинское изделие

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР,
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, P.R. China**

Производитель

**"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР,
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, P.R. China**

Место производства медицинского изделия

**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 1203 Nanhuan Avenue,
Guangming District, 518106 Shenzhen, People's Republic of China**

Номер регистрационного досье № РД-63403/50031 от 27.06.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 15 октября 2024 года № 5895
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0079154

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 октября 2024 года № РЗН 2024/23788

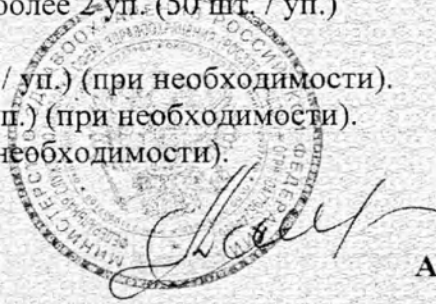
Лист 1

На медицинское изделие

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600, в составе:

1. Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600 - 1 шт.
2. Руководство оператора - 1 шт.
3. Кабель для подключения к источнику питания - 1 шт.
4. Модуль автоматической загрузки проб мочи - 1 шт.
5. Линия автозагрузчика - 2 шт.
6. Передняя накладка - 1 шт.
7. Трубка для сброса отходов - 1 шт.
8. Трубка для очищающего раствора - 1 шт.
9. Винт для крепления к поддону - 6 шт.
10. Блок для бумажных отходов - 1 шт.
11. Программное обеспечение на USB-носителе - 1 шт.
12. Бутыль для жидких отходов, 5 литров - 1 шт. (при необходимости).
13. Пробирки для анализа мочи, для запуска анализатора - 1 уп. (50 шт. / уп.) (при необходимости).
14. Штатив для пробирок с мочой - 10 шт. (при необходимости).
15. Кабель соединительный - 1 шт. (при необходимости).
16. Сканер штрих-кодов внешний - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 16.1. Сканер штрих-кодов - 1 шт.
 - 16.2. Кабель сканера штрих-кодов - 1 шт.
17. Набор последовательного подключения - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 17.1. Кабель для последовательного подключения на 4 порта - 1 шт.
 - 17.2. Плата для последовательного подключения - 1 шт.
 - 17.3. Кронштейн - 1 шт.
 - 17.4. Винт - 8 шт.
 - 17.5. Драйвер на CD носителе - 1 шт.
18. Крепежи L-образные - 2 шт. (при необходимости).
19. Коробка для отходов - 1 шт. (при необходимости).
20. Коробка для бумажных отходов - 1 шт. (при необходимости).
21. Держатель для пробирок желтый - не более 2 уп. (50 шт. / уп.) (при необходимости).
22. Адаптер для пробирок - 1 уп. (100 шт. / уп.) (при необходимости).
23. Заглушки для винтов - 1 уп. (12 шт. / уп.) (при необходимости).
24. Предохранитель плавкий - 3 шт. (при необходимости).


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0148785