


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Пробирка нестерильная для лабораторных работ по ТУ 32.50.50-012-48072026-2022 в вариантах
исполнения,
производства ООО «Компания Совтех»**

1. Пробирка 0,1 мл, без крышки

а) изображение изделия

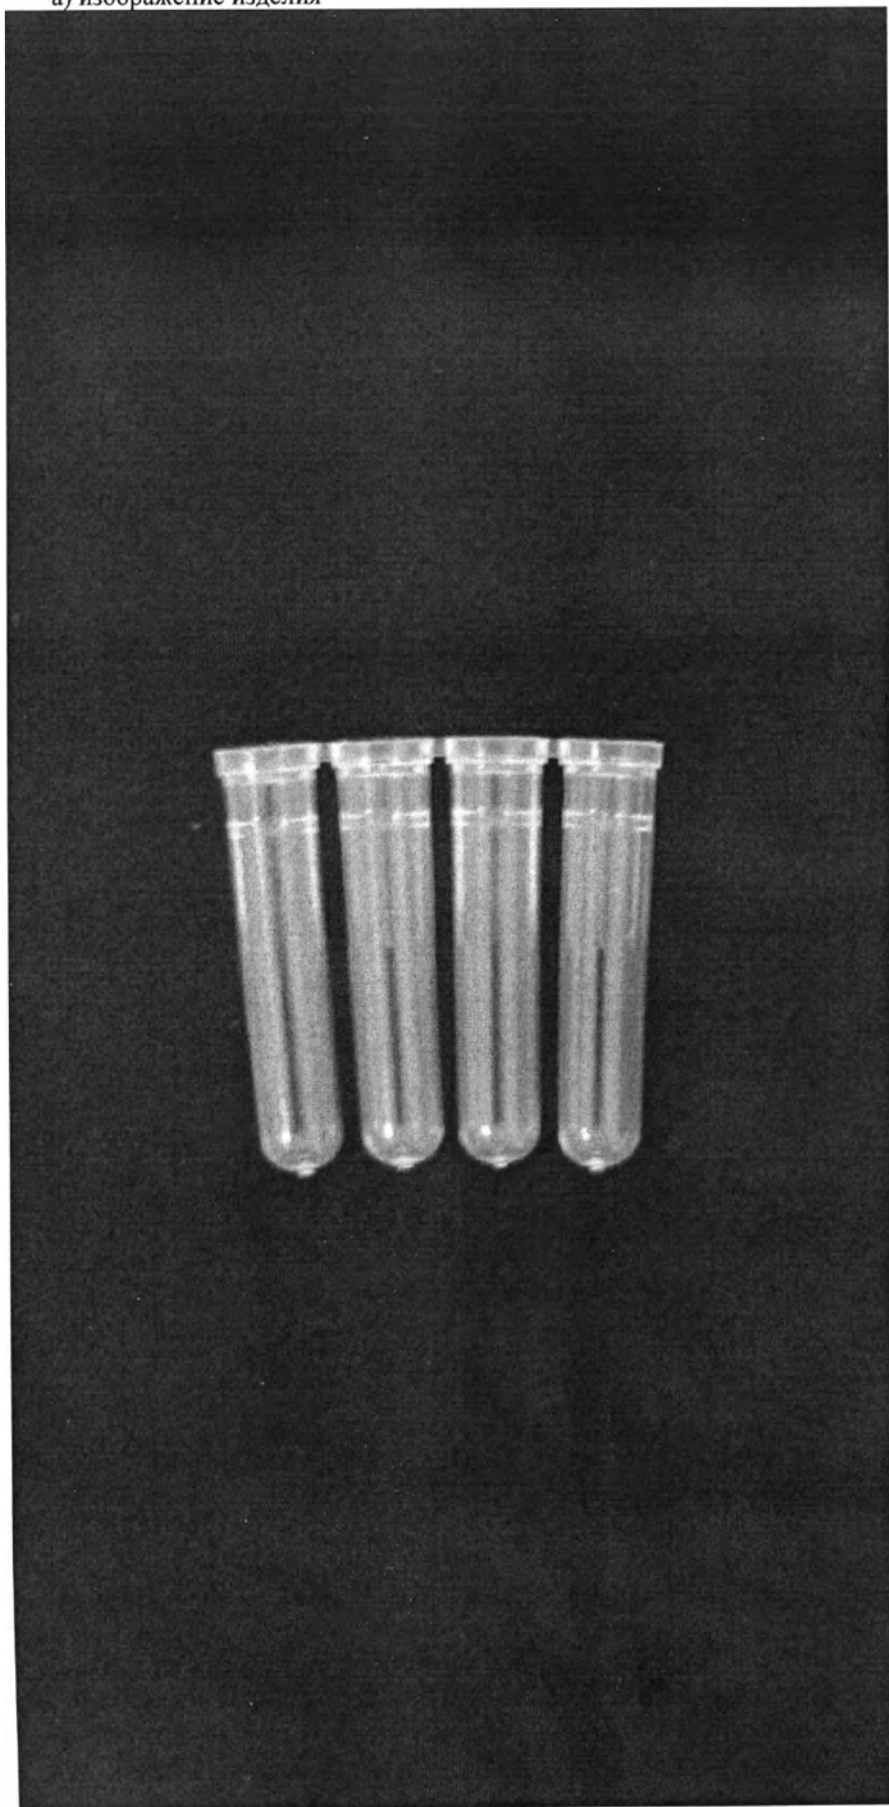


б) изображение маркировки

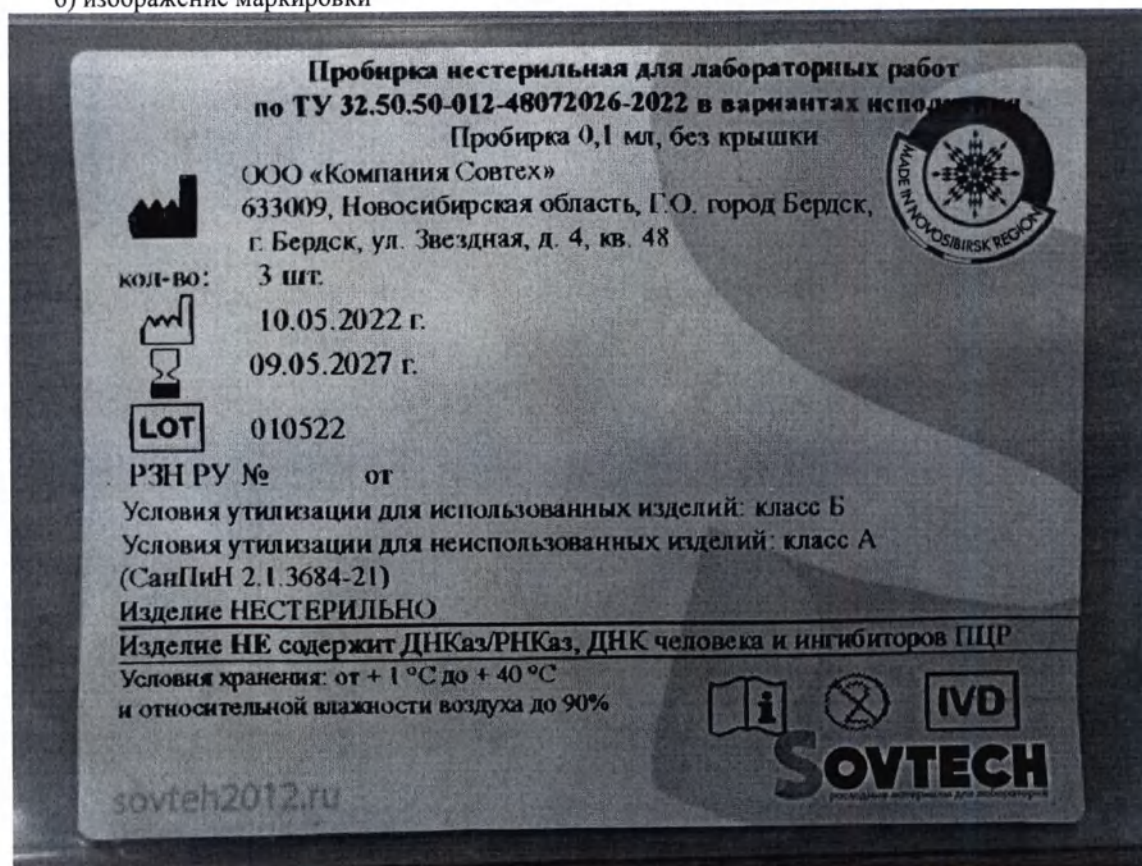

2. Пробирка 0,1 мл, в комплекте с крышками

а) изображение изделия

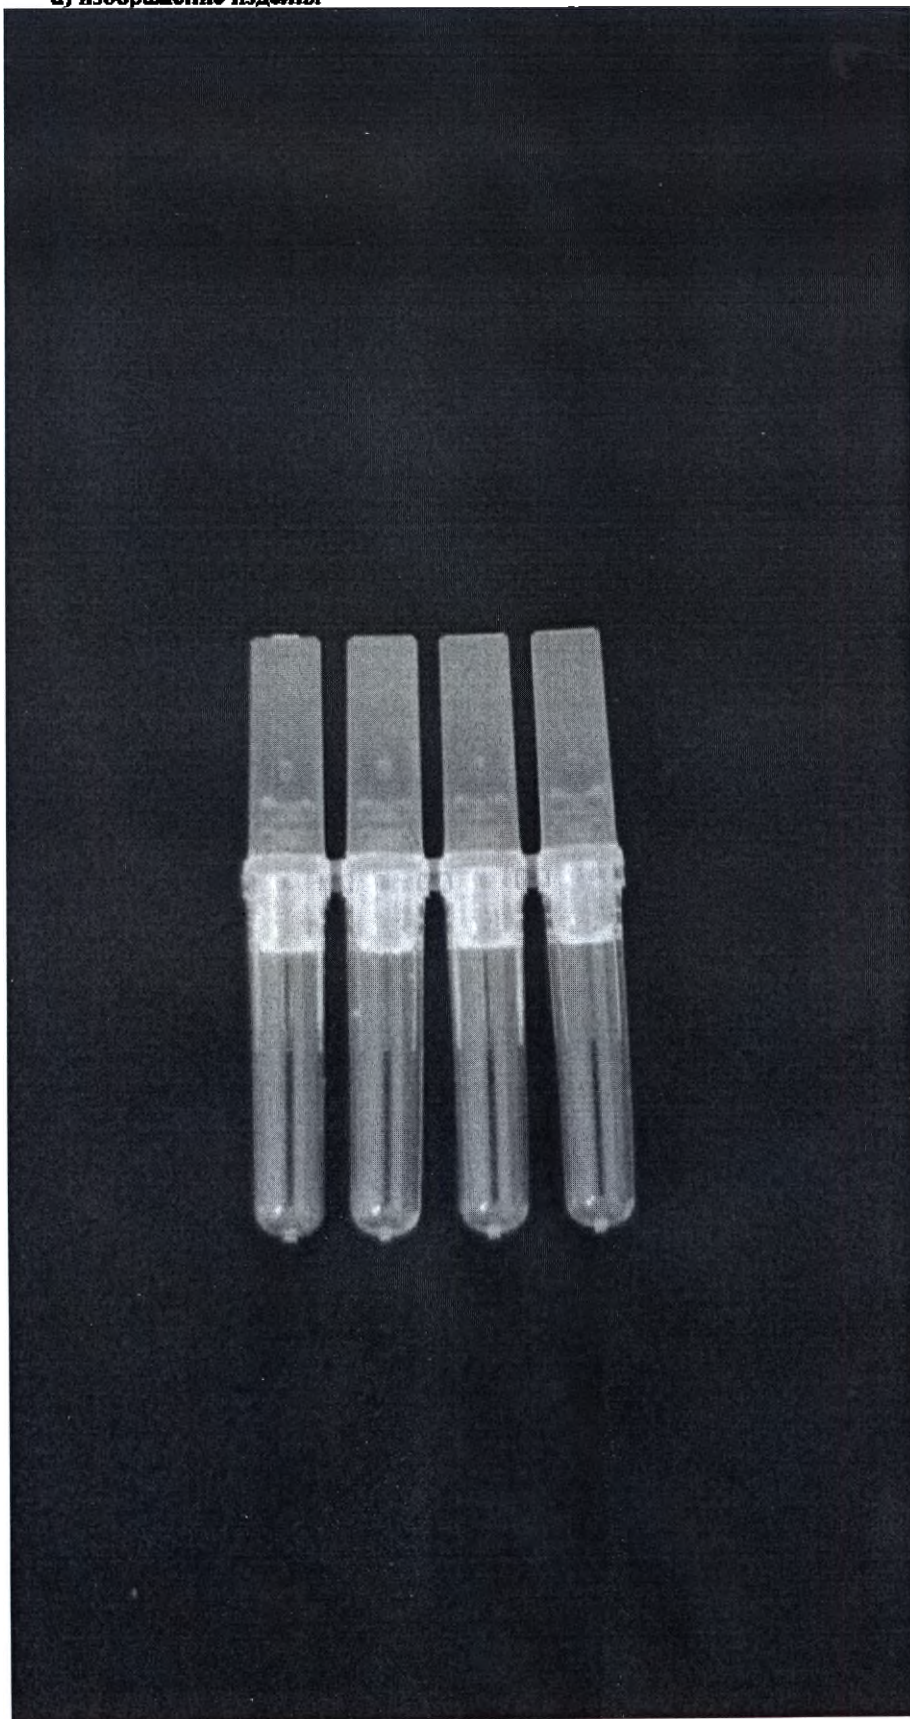


б) изображение маркировки




3. Пробирка 0,2 мл, с крышкой

а) изображение изделия

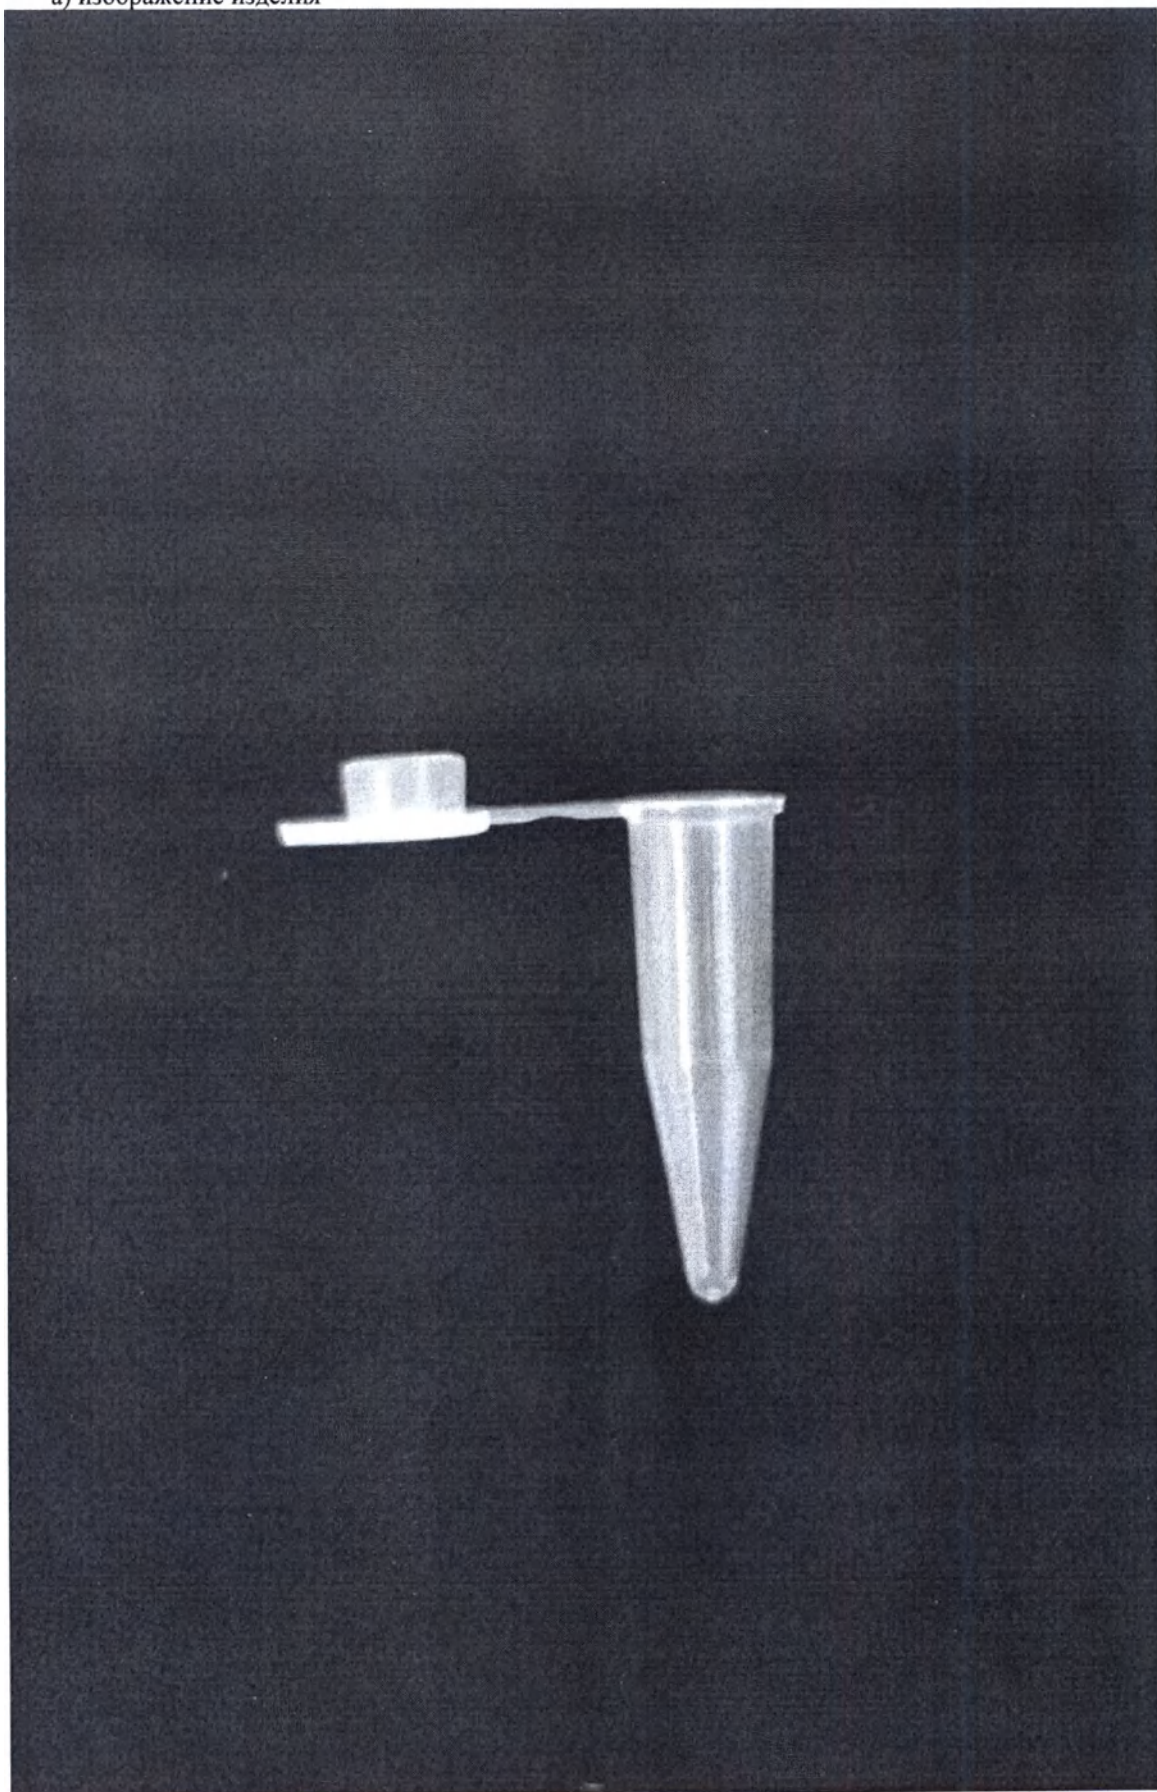


б) изображение маркировки

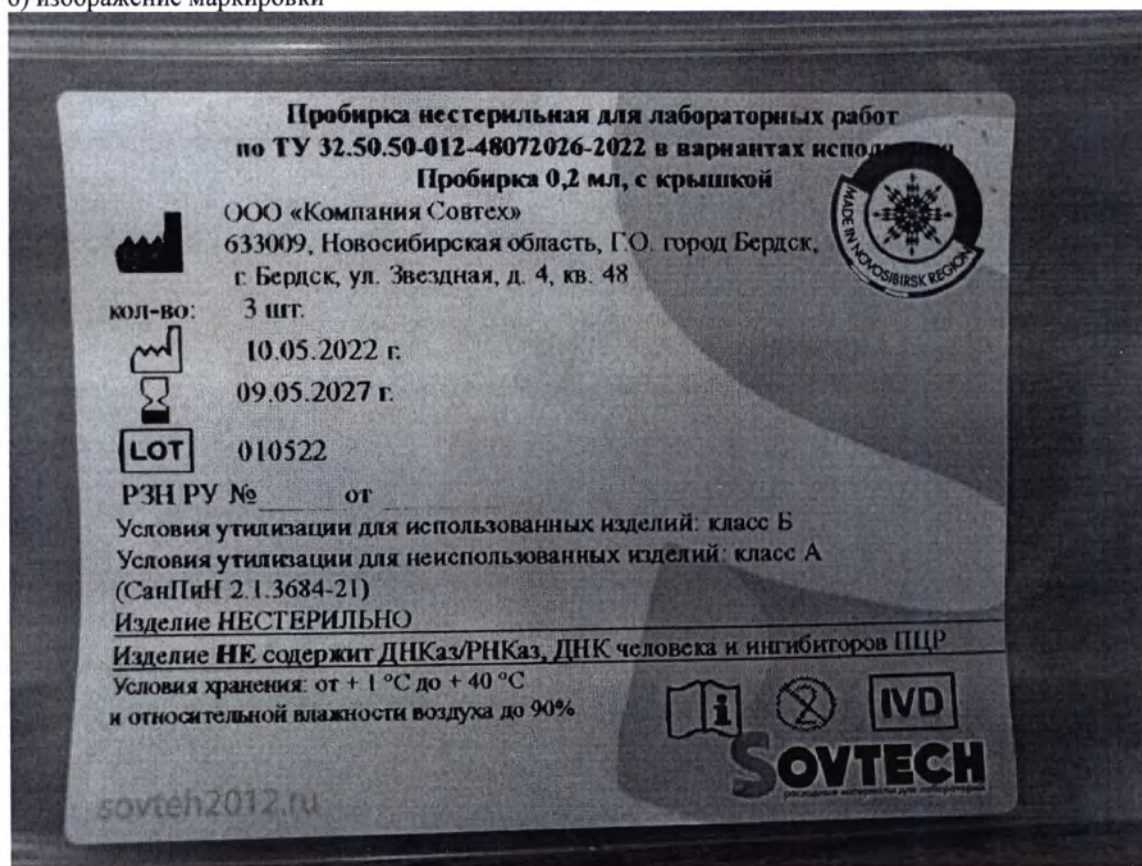

4. Пробирка ПЦР 0,5 мл, с крышкой

а) изображение изделия

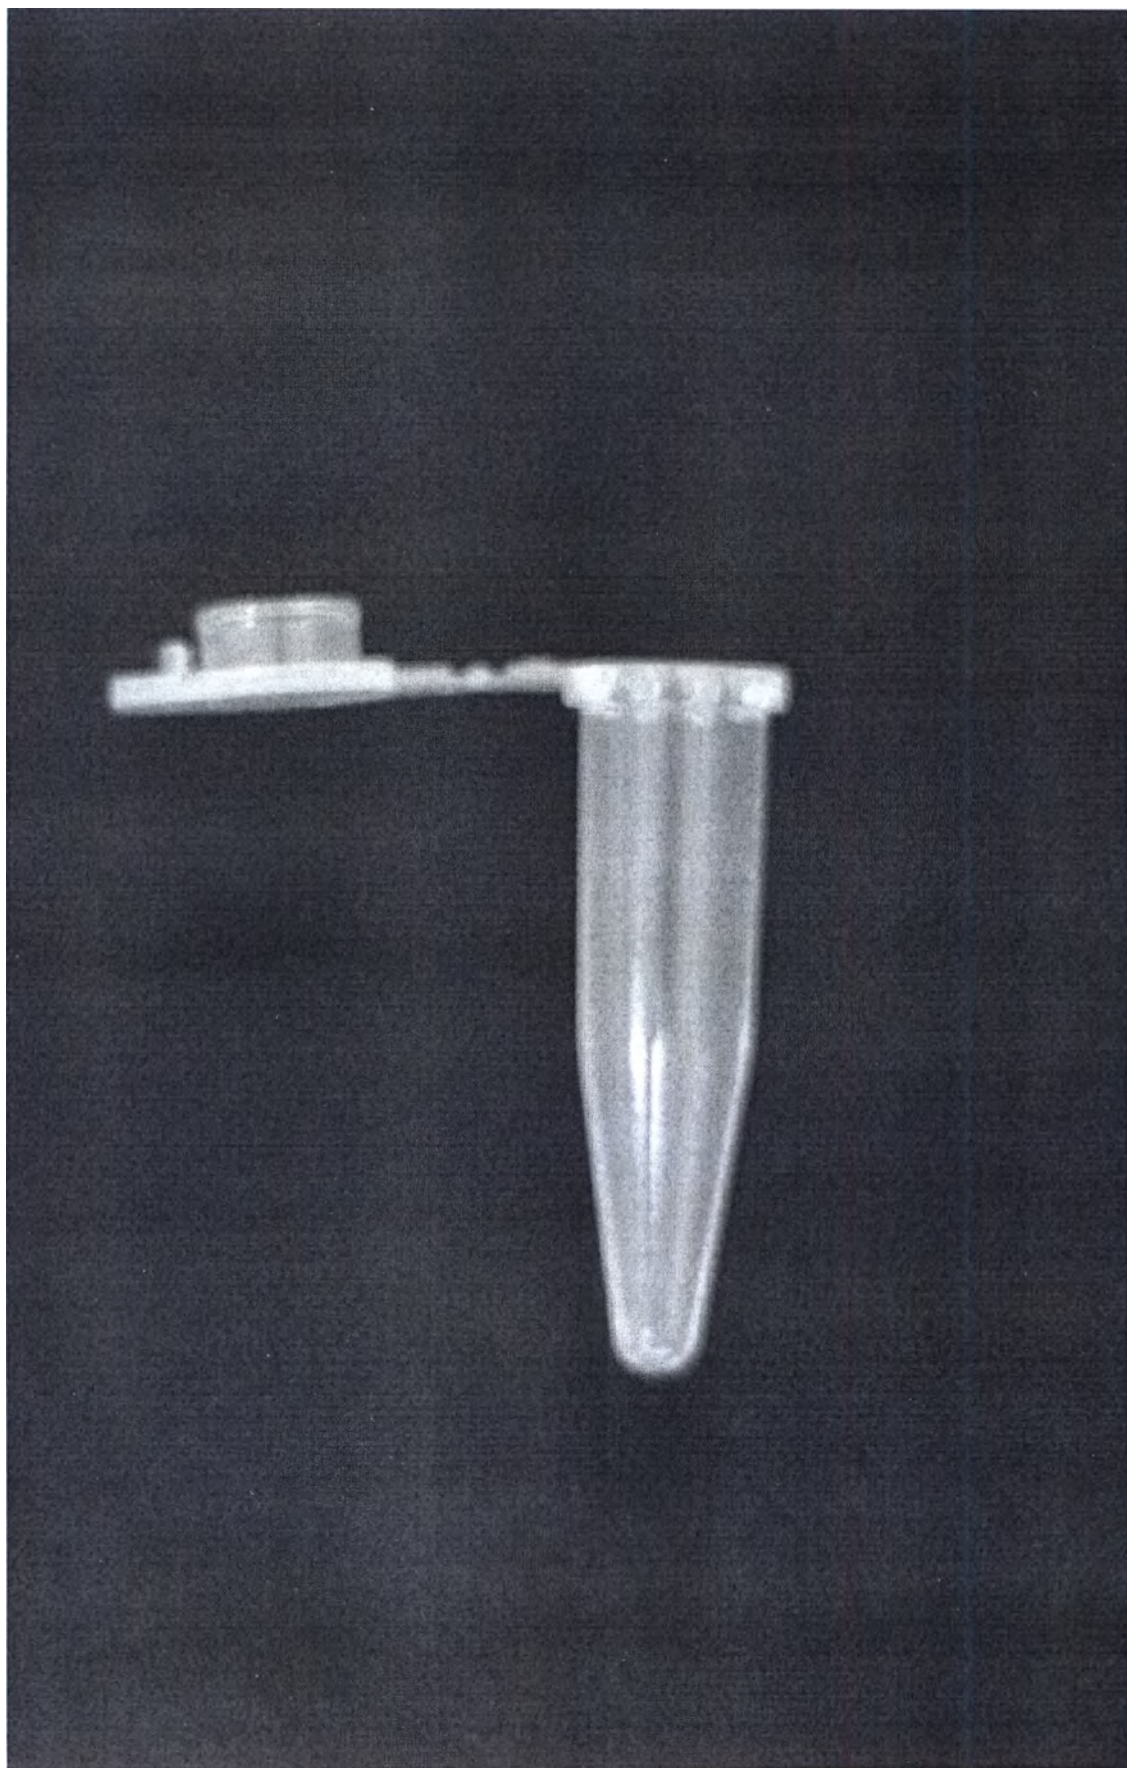


б) изображение маркировки



5. Пробирка 0,6 мл, с крышкой

а) изображение изделия

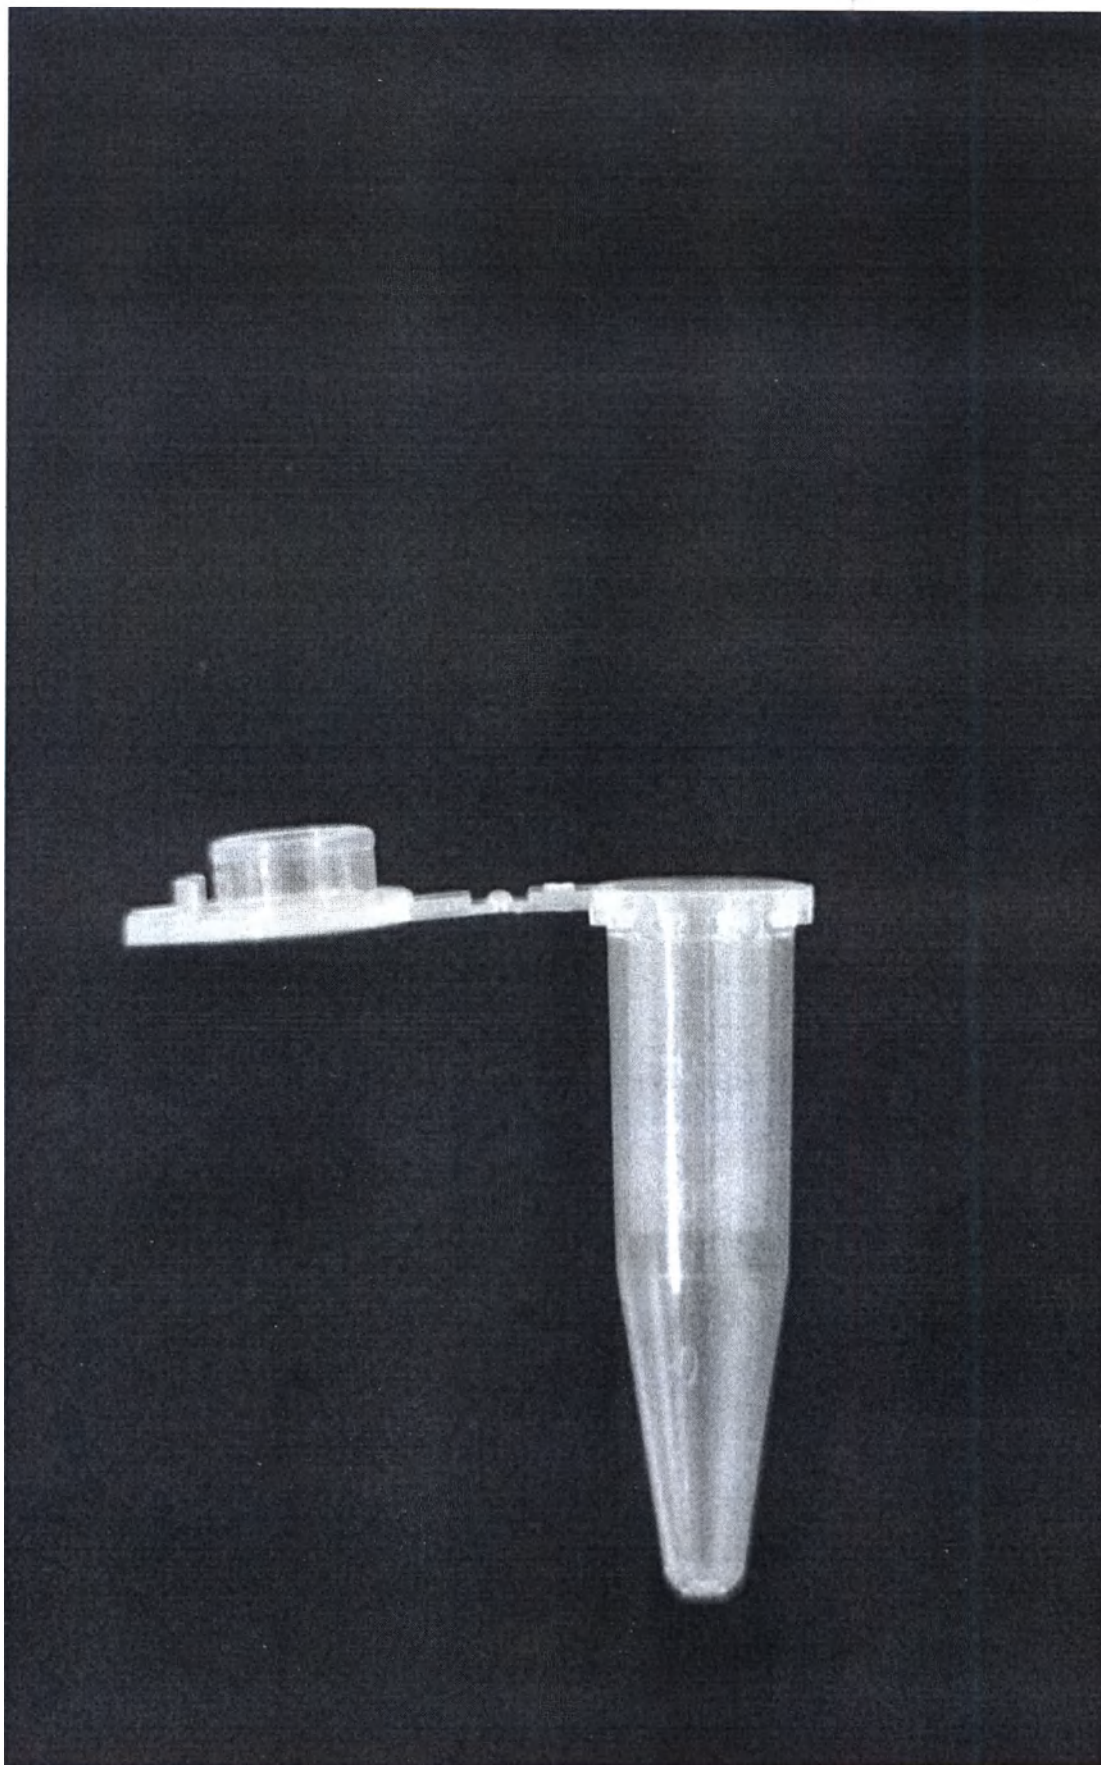

б) изображение маркировки



6. Пробирка 1,5 мл, с крышкой

а) изображение изделия




б) изображение маркировки



7. Пробирка 1,5 мл, без крышки

а) изображение изделия

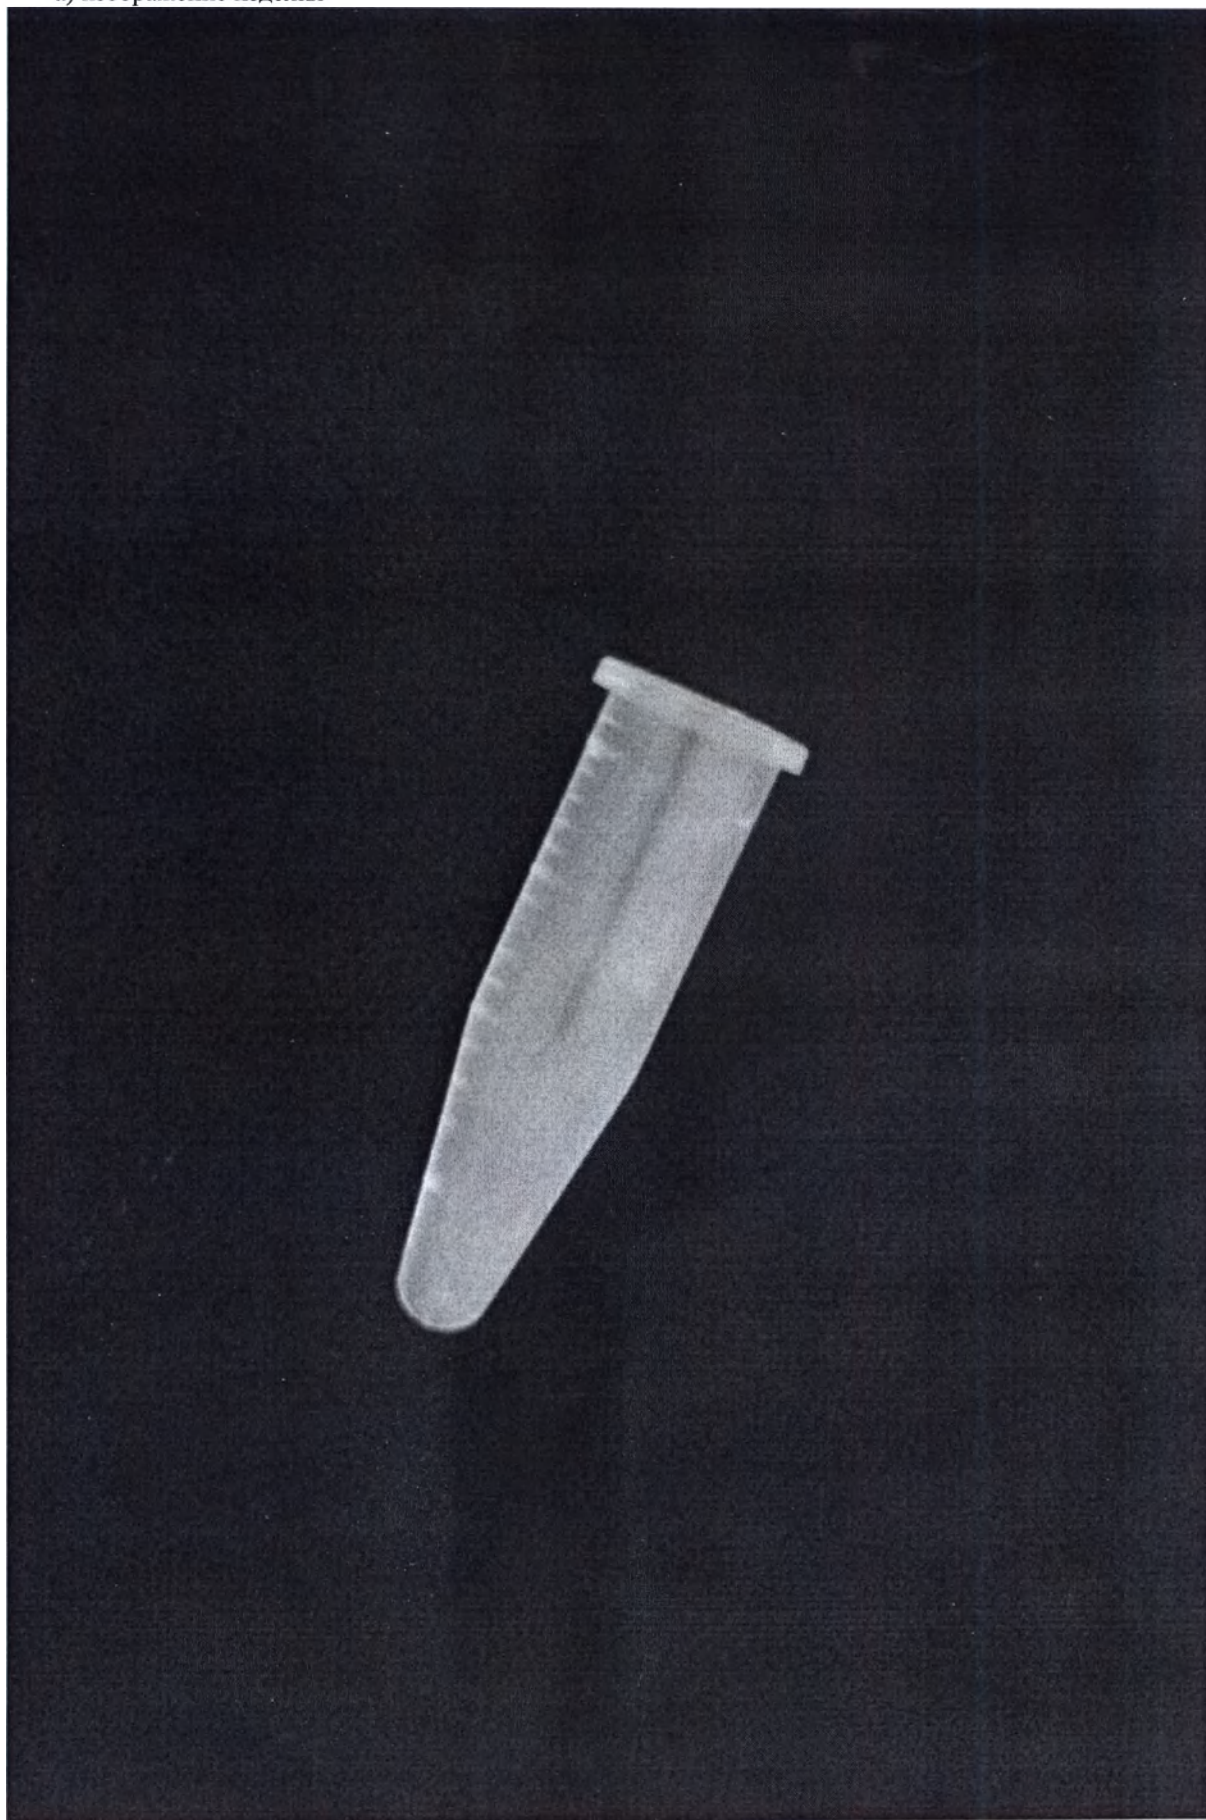


б) изображение маркировки



8. Пробирка 2 мл, с крышкой

а) изображение изделия

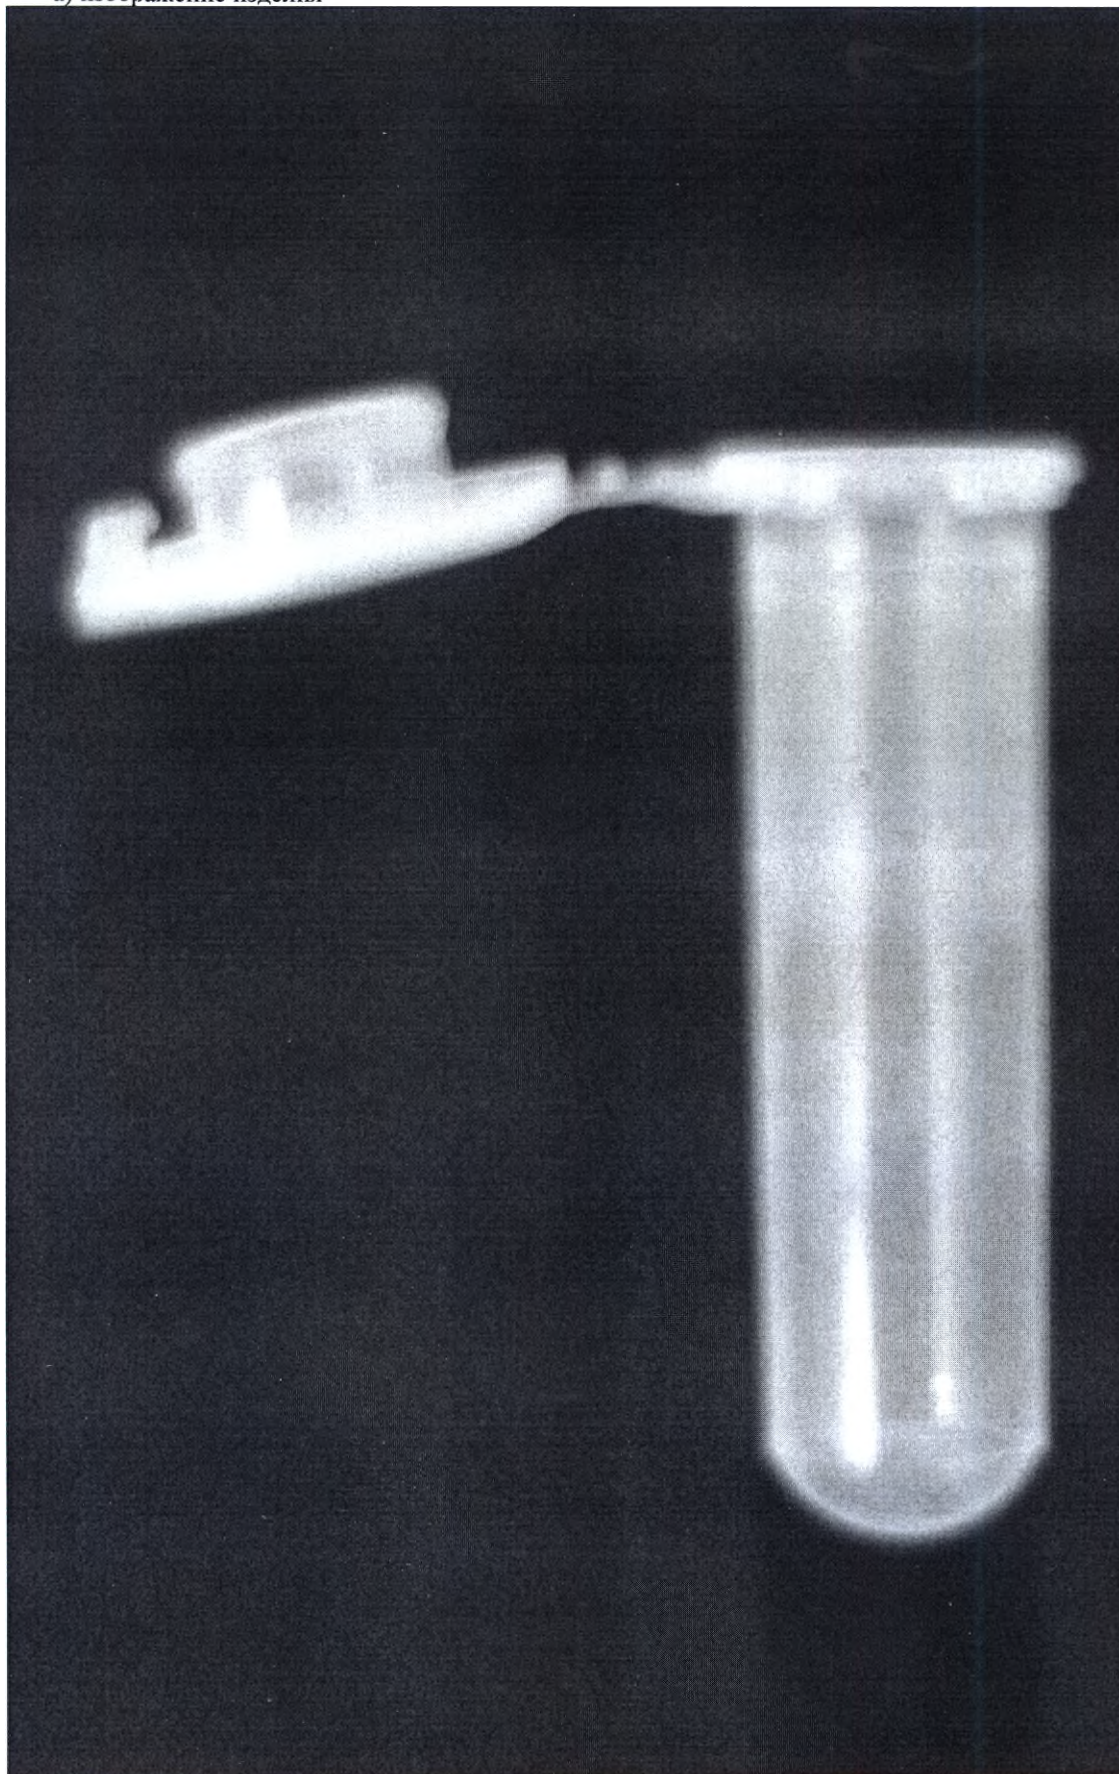


б) изображение маркировки




9. Пробирки 0,1 мл в стрипах, низкий профиль, 1x8, без, крышек

а) изображение изделия

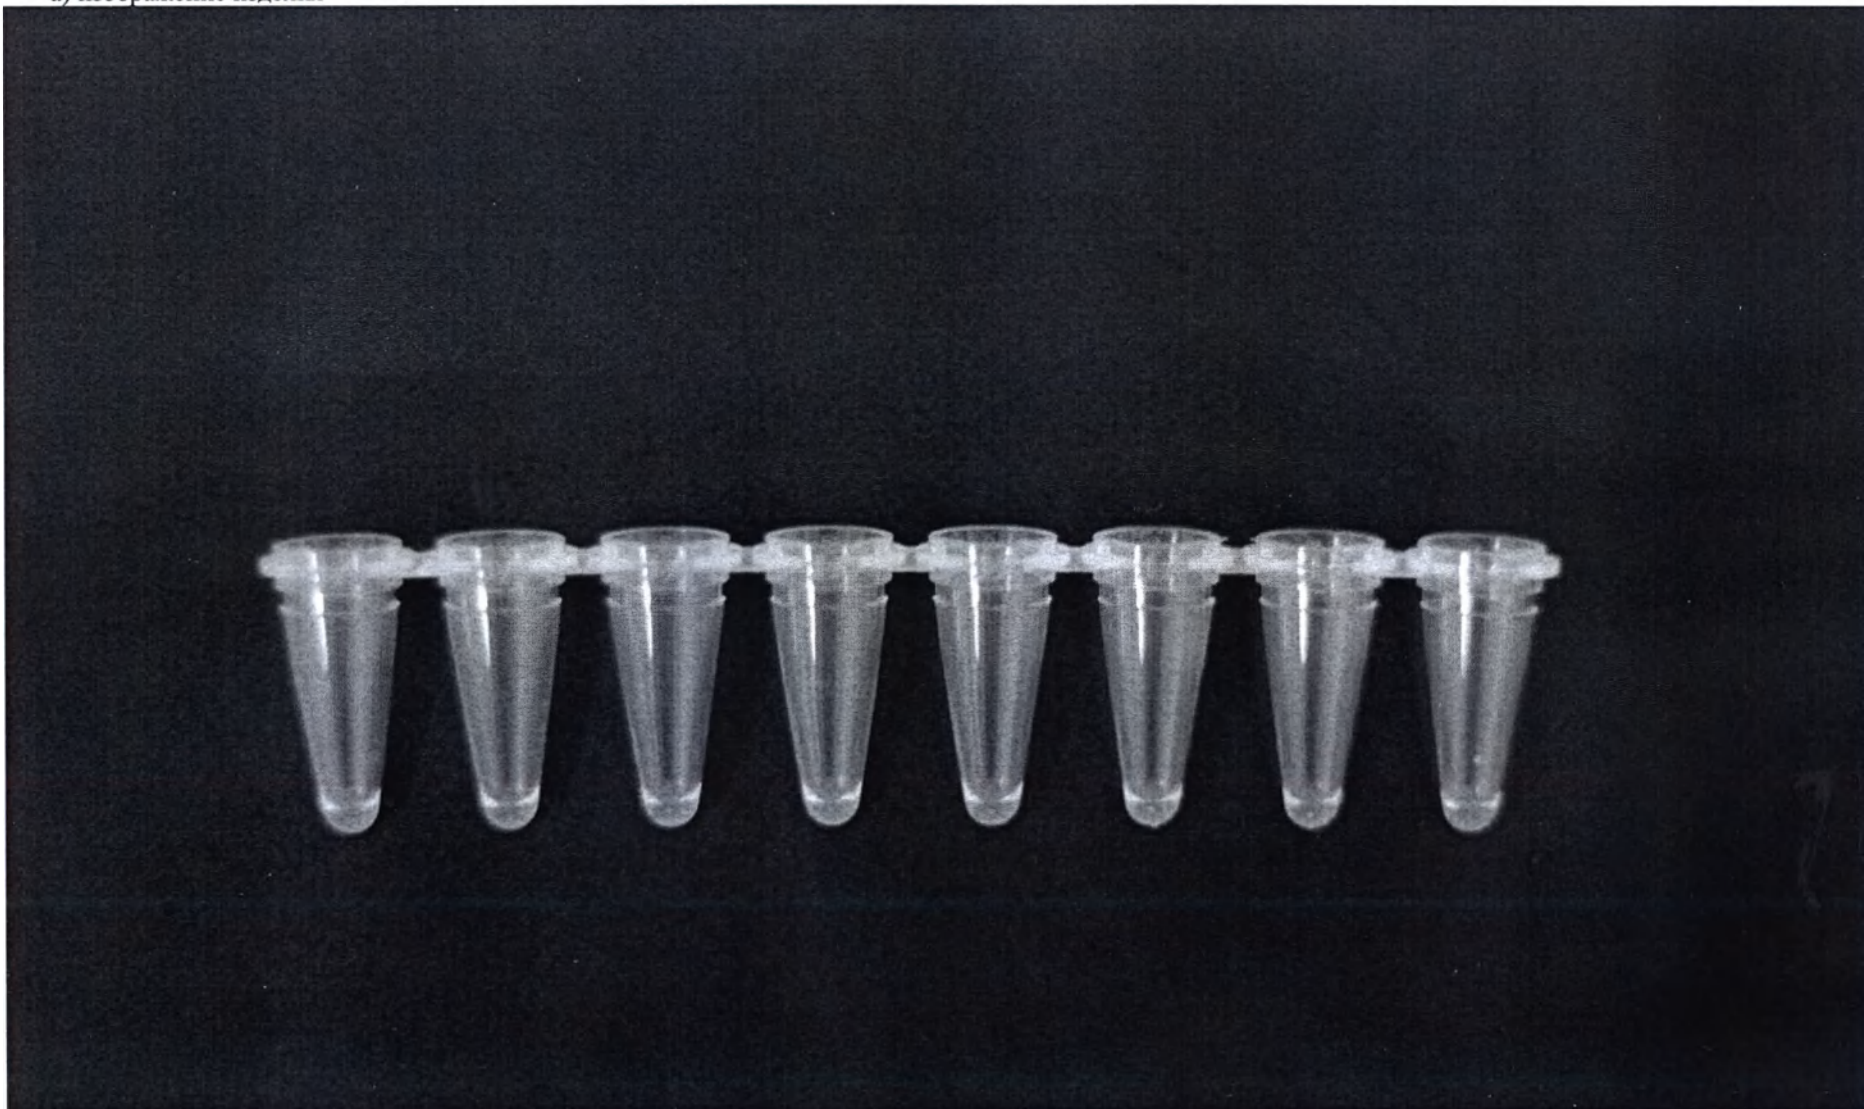


б) изображение маркировки

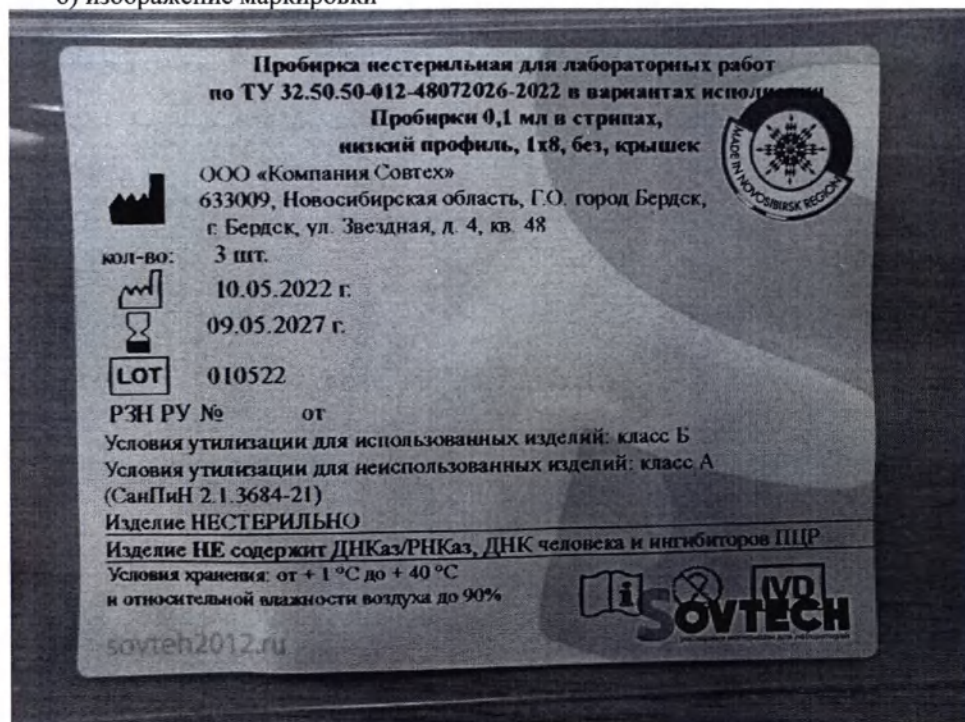


10. Пробирки 0,1 мл в стрипах, низкий профиль, 1x8, в комплекте с крышками

а) изображение изделия

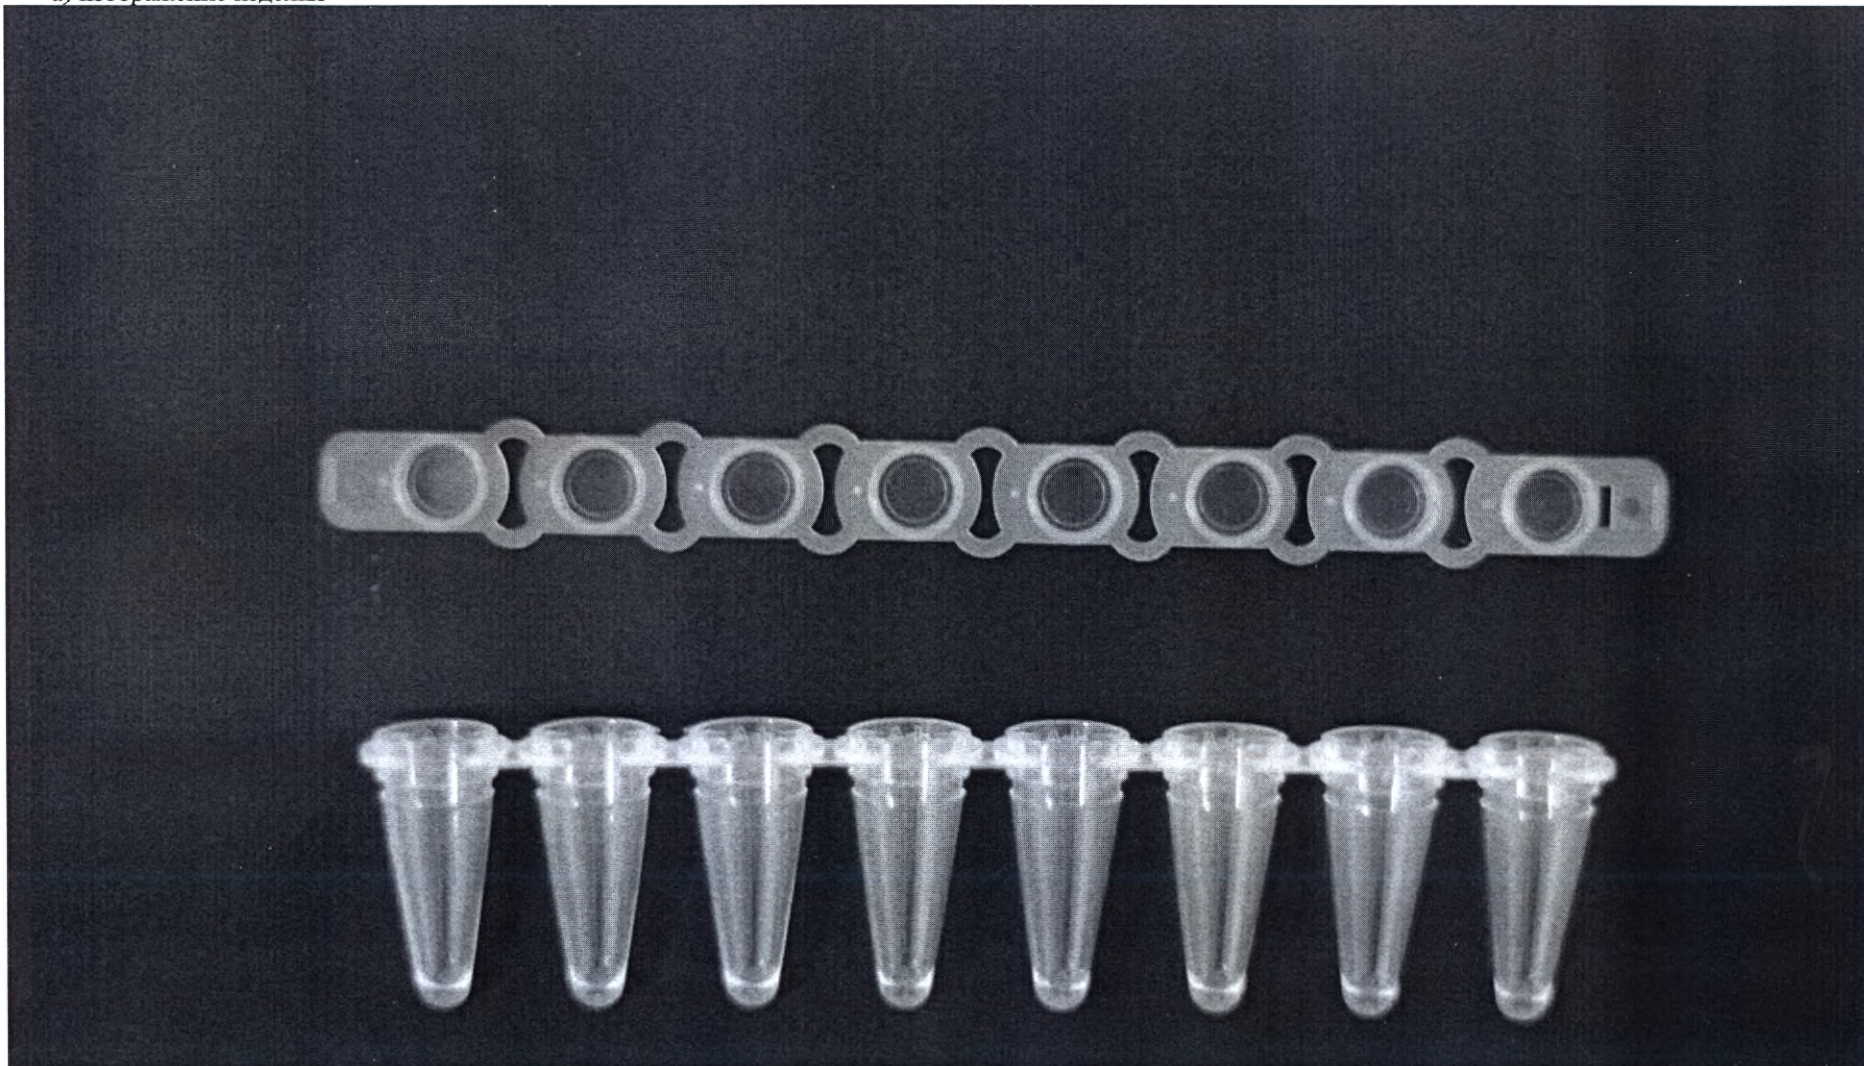


б) изображение маркировки

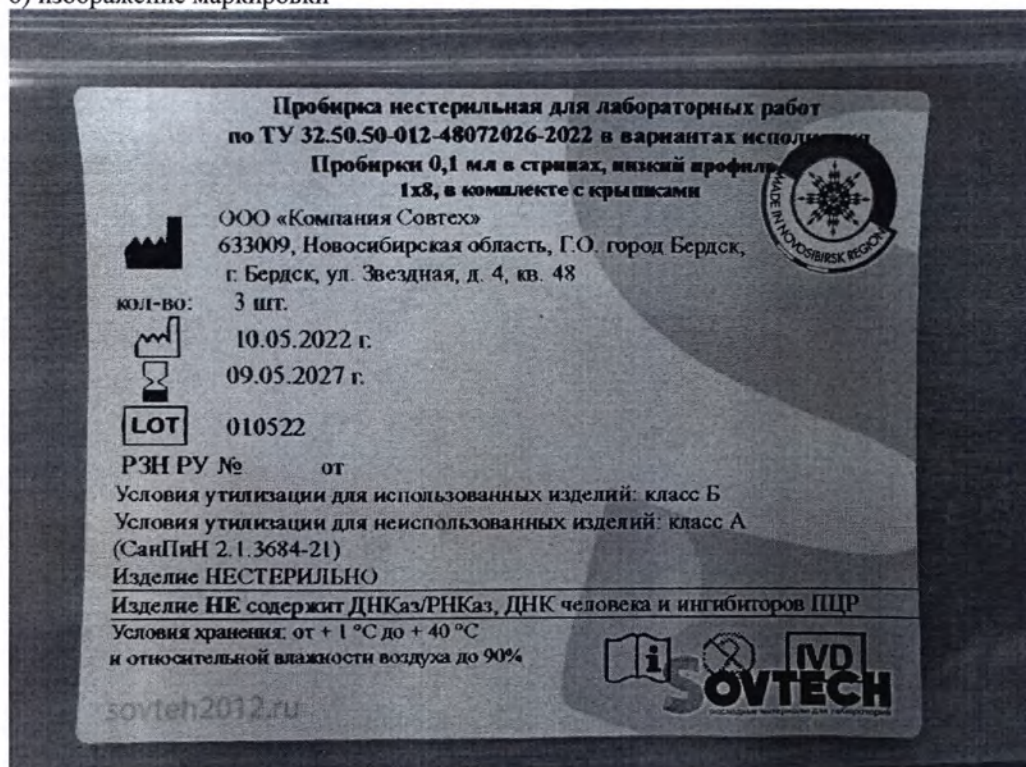


11. Пробирки 0,1 мл в стрипах, низкий профиль, 1х8, с прикрепленными крышками

а) изображение изделия

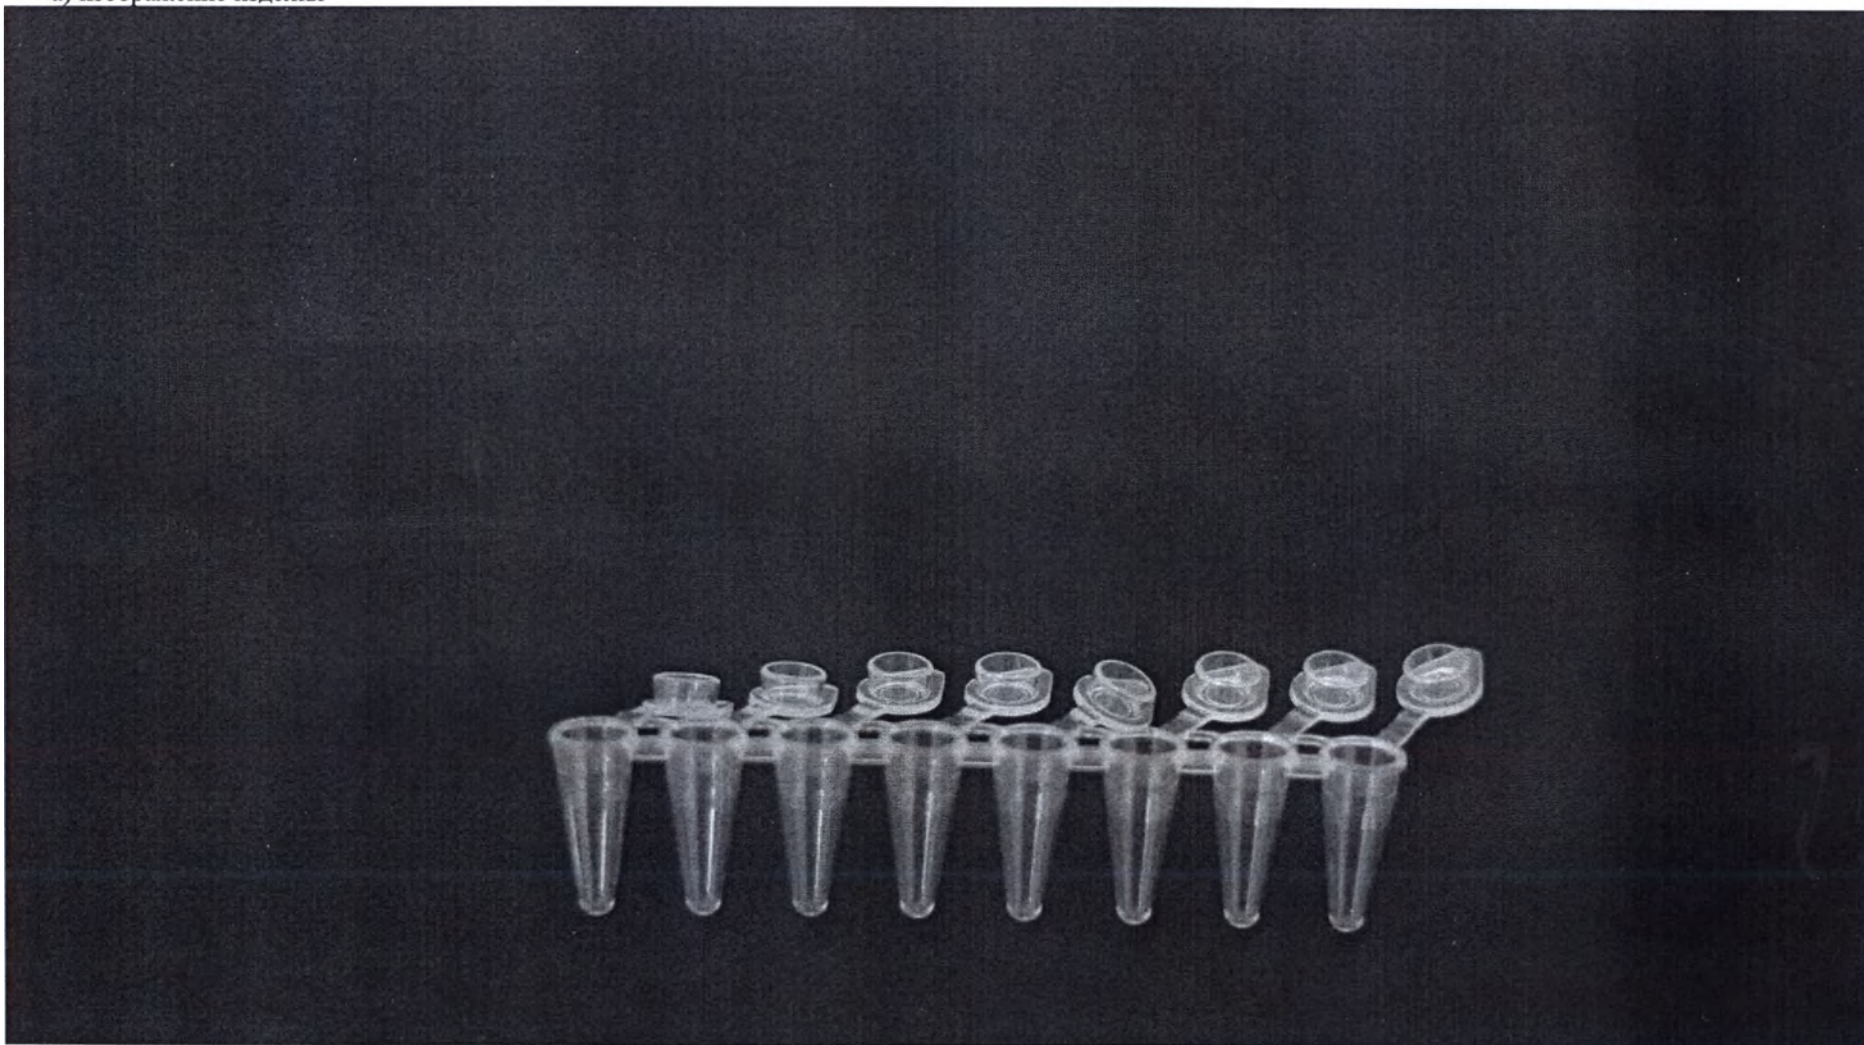


б) изображение маркировки

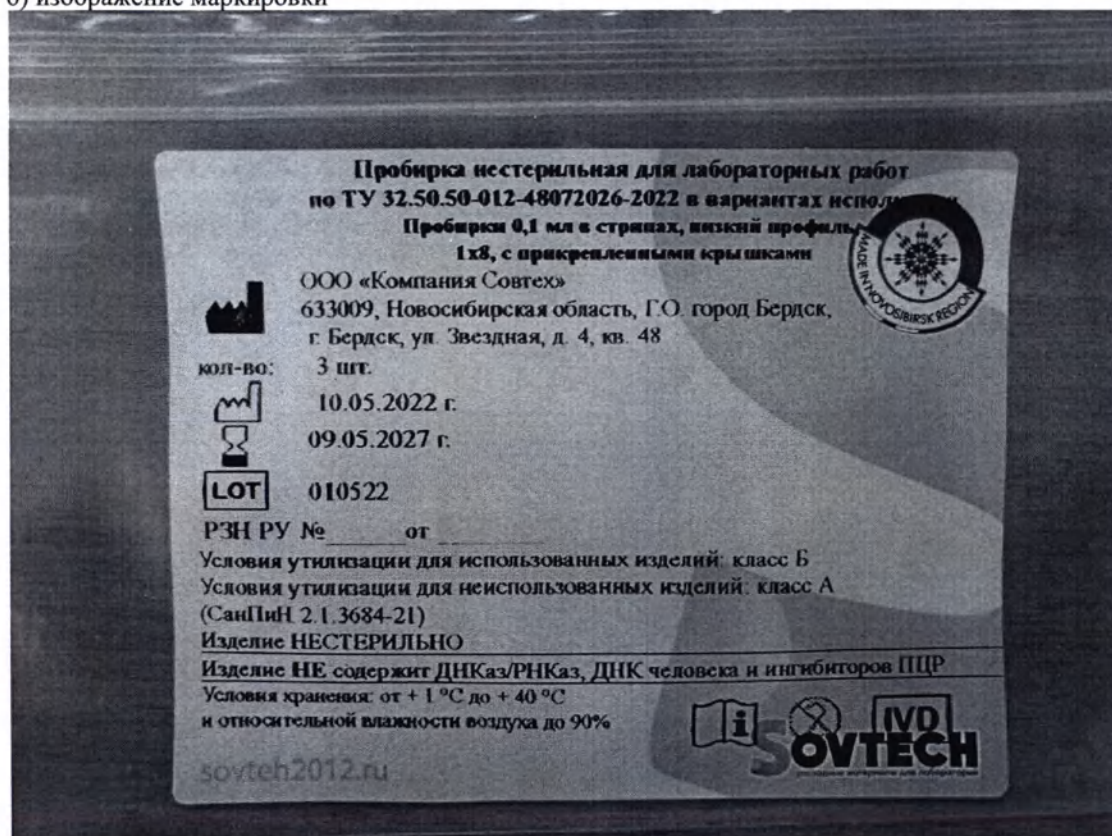


12. Пробирки 0,2 мл в стрипах, стандартный профиль, 1x8, без крышек

а) изображение изделия

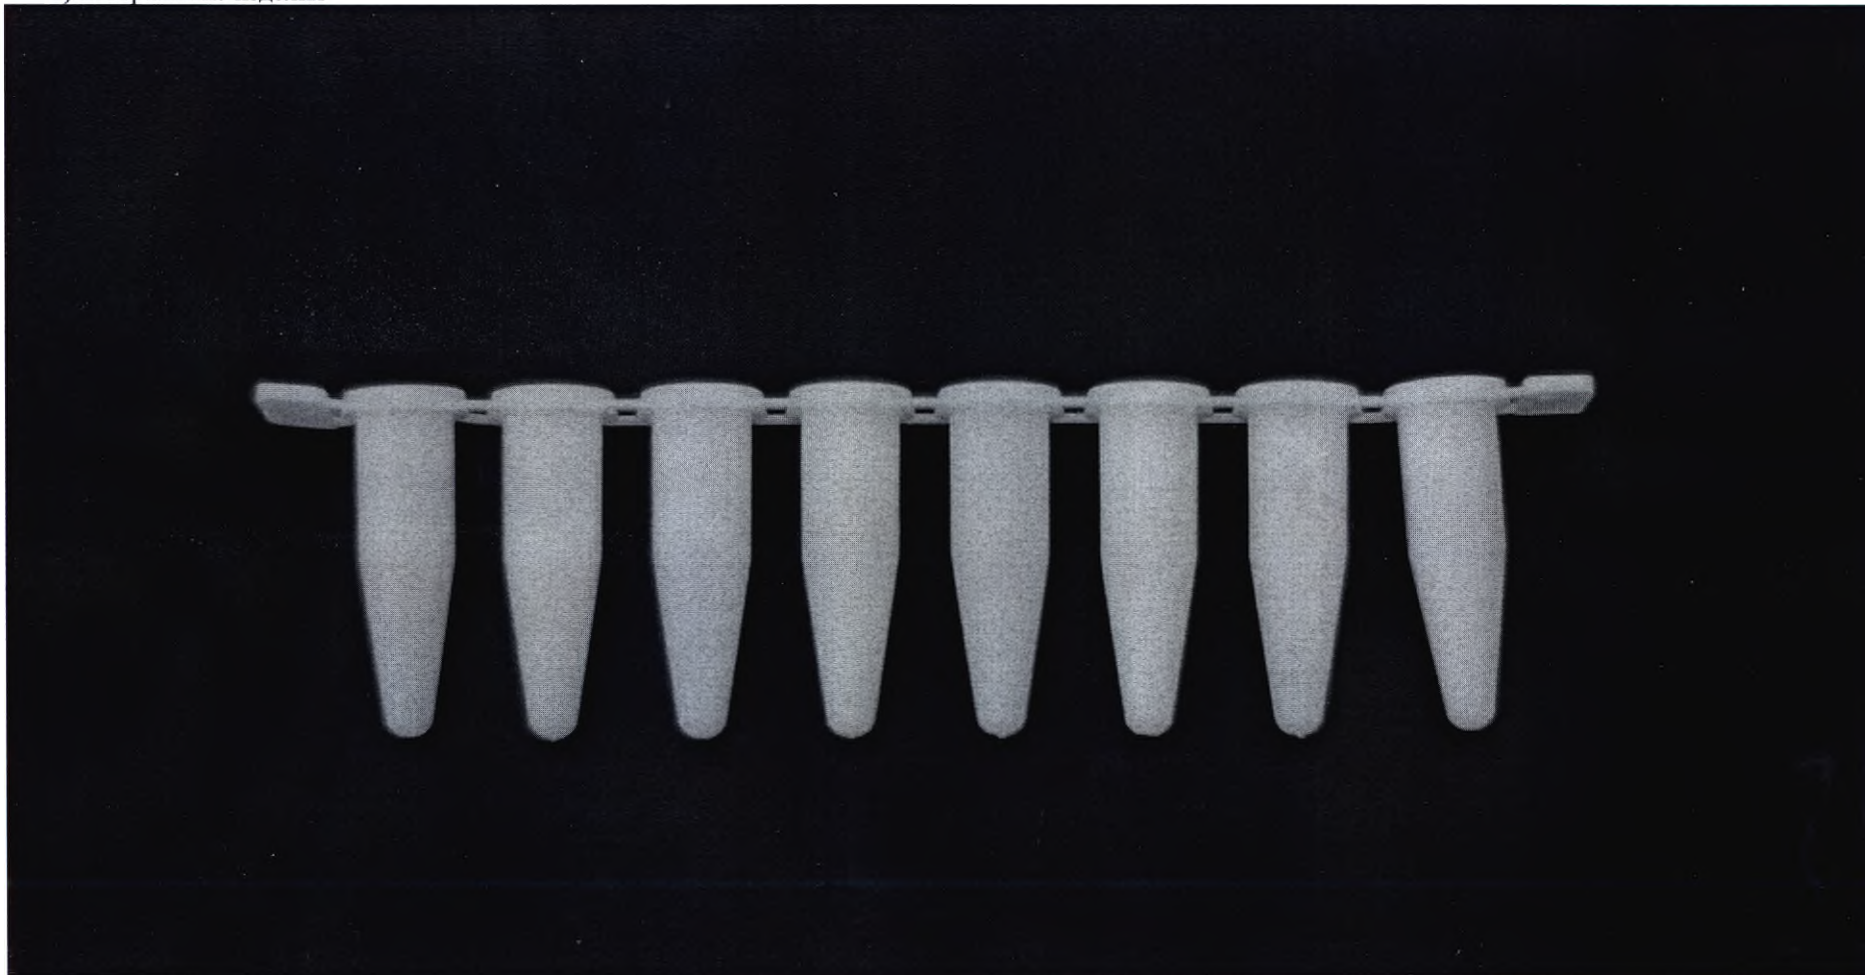


б) изображение маркировки

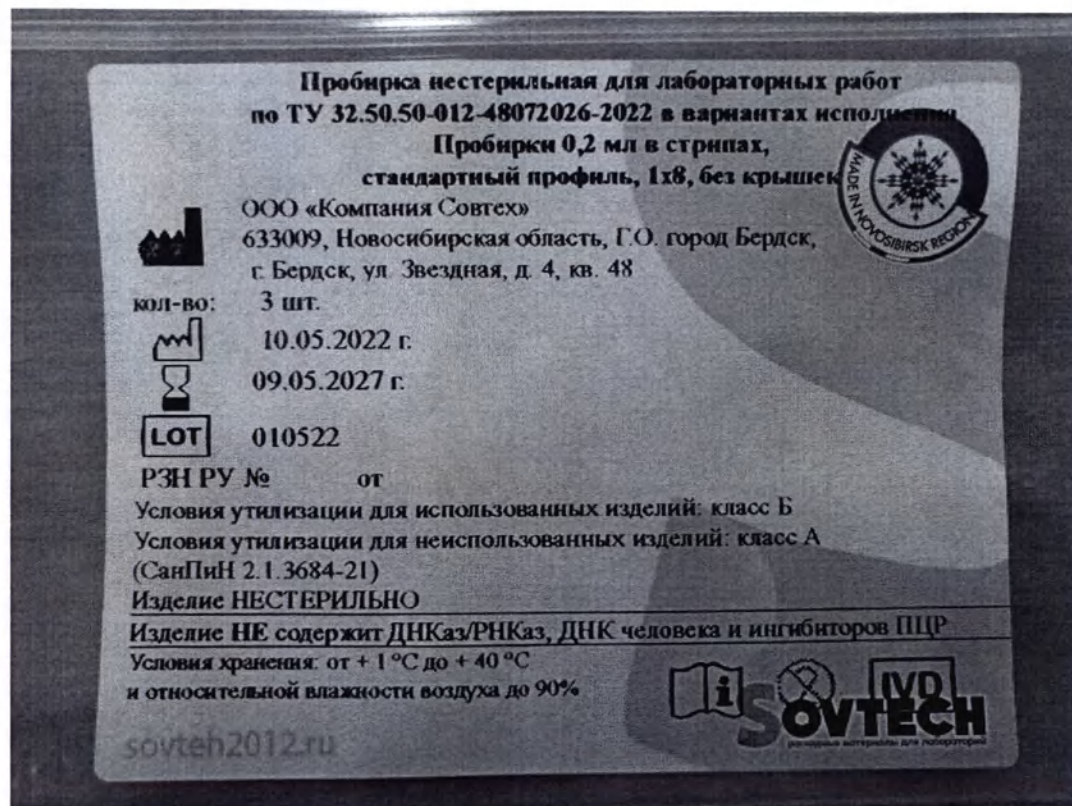


13. Пробирки 0,2 мл в стрипах, стандартный профиль, 1х8, в комплекте с крышками

а) изображение изделия

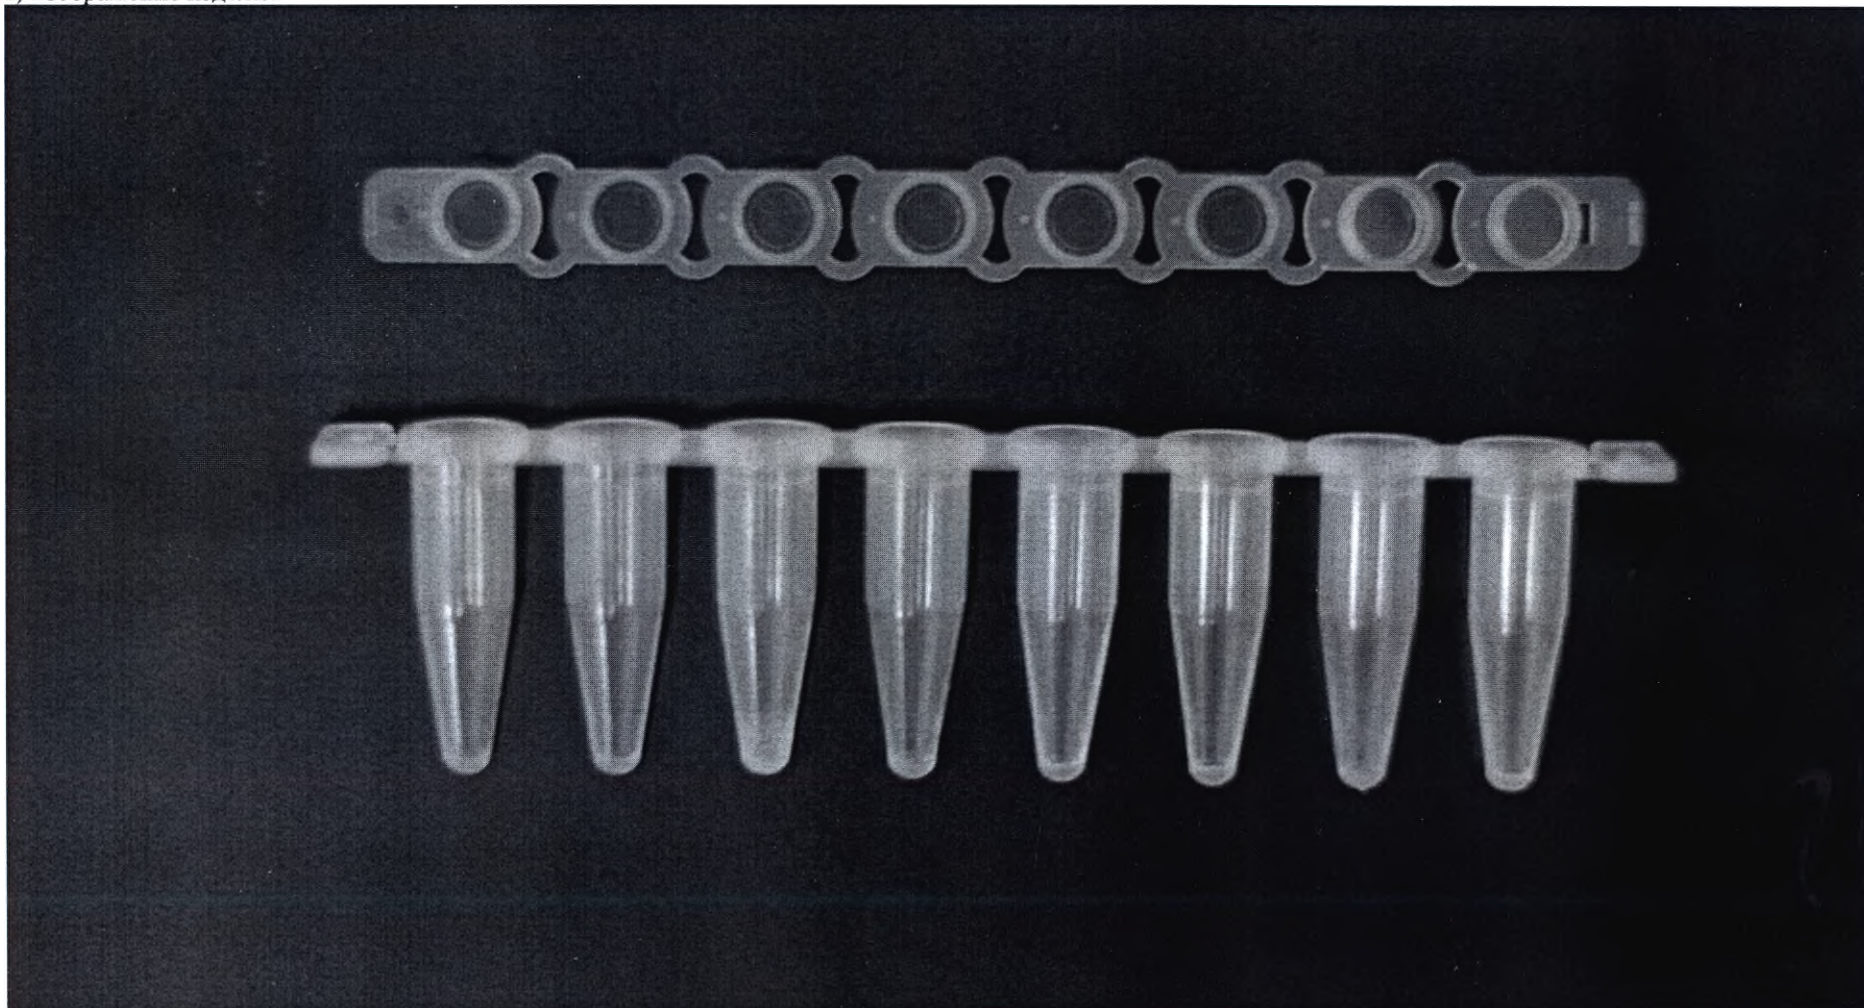


б) изображение маркировки

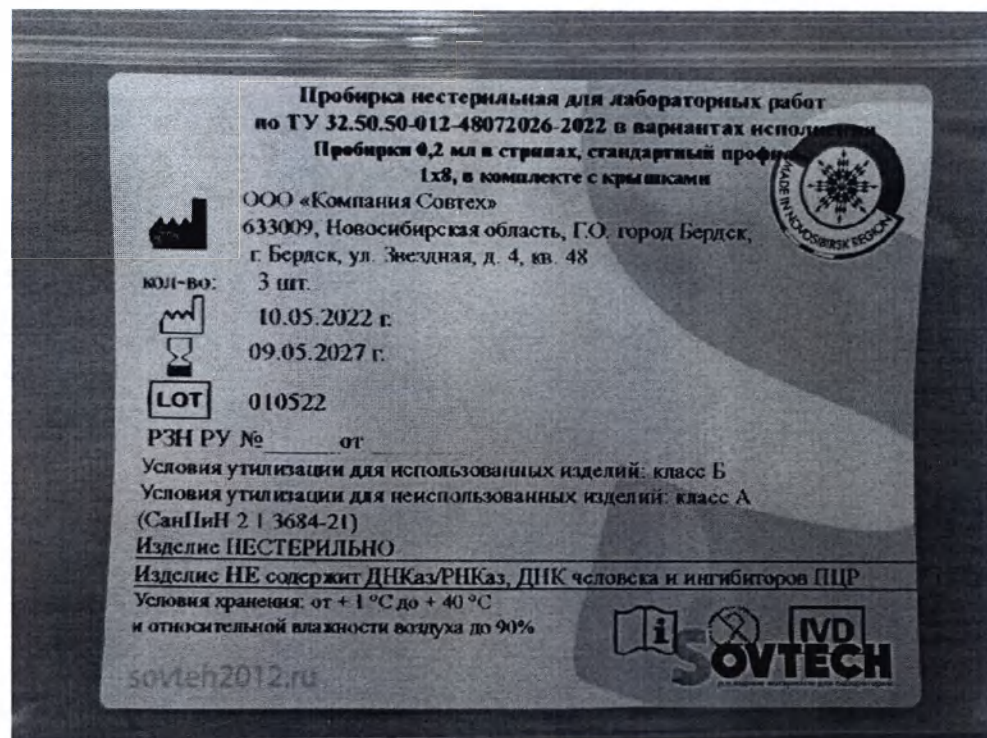


14. Пробирки 0,2 мл в стрипах, стандартный профиль, 1x8, с прикрепленными крышками

а) изображение изделия

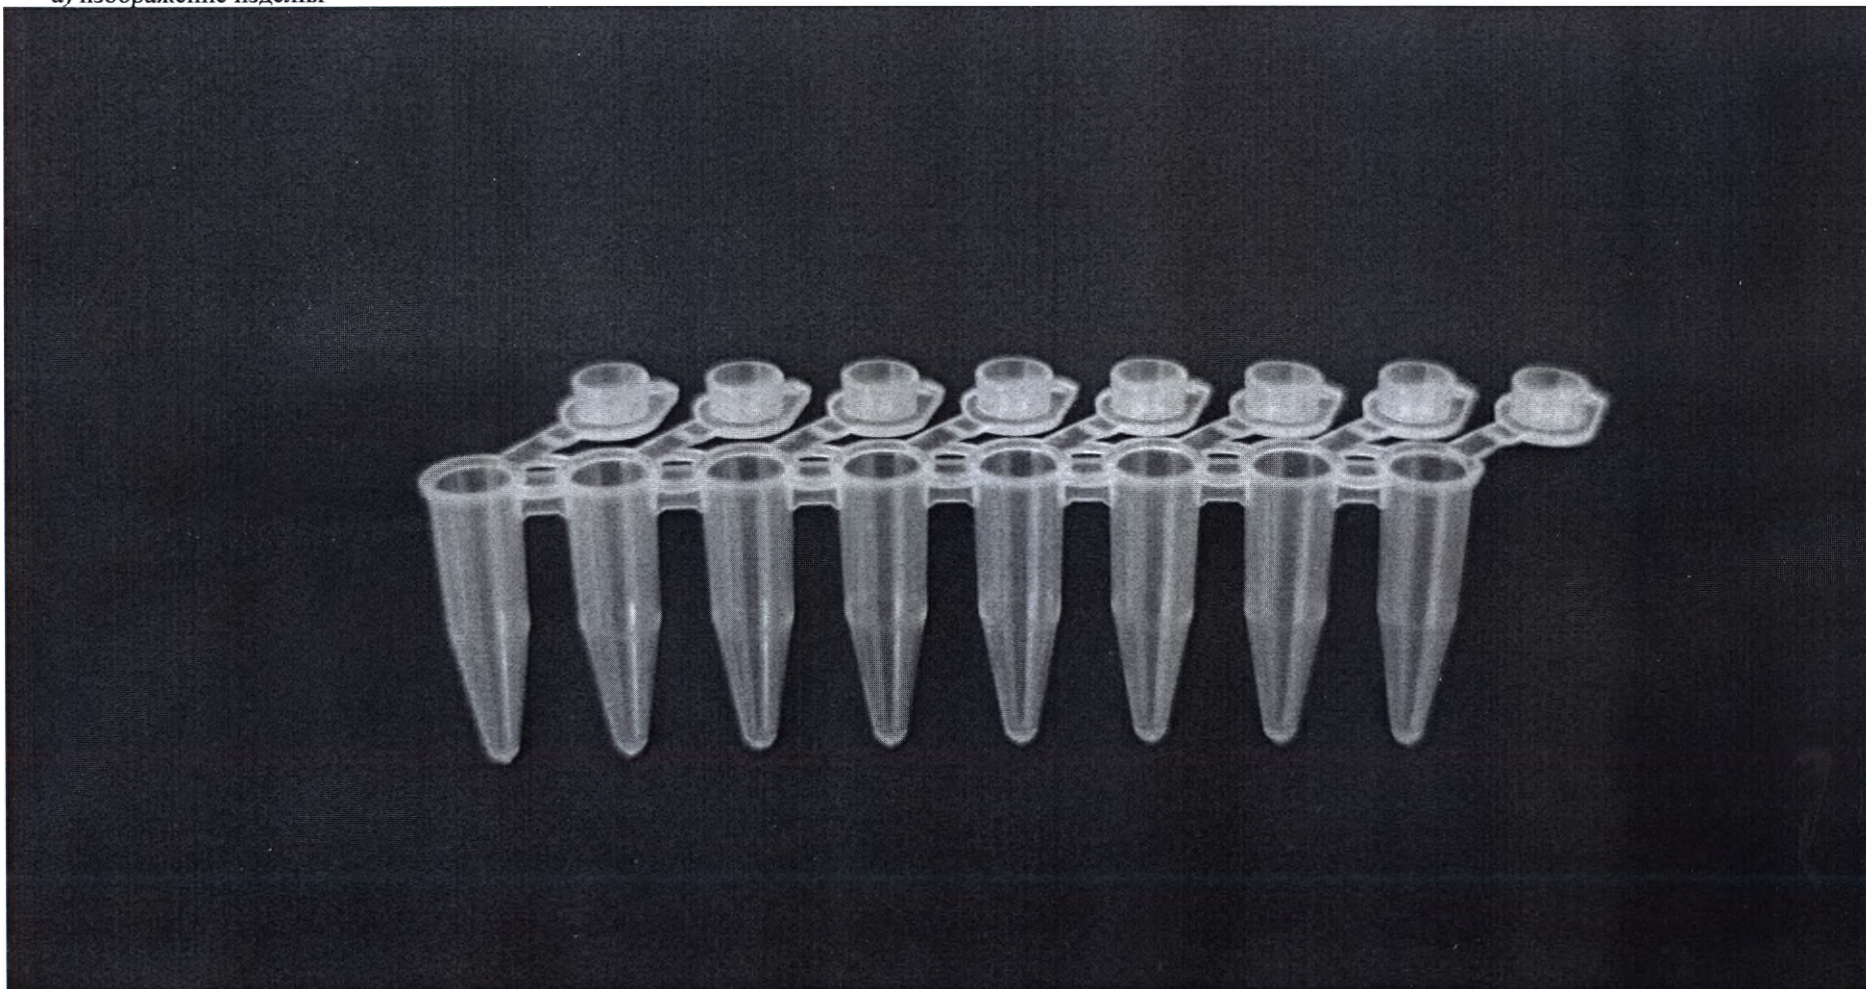


б) изображение маркировки

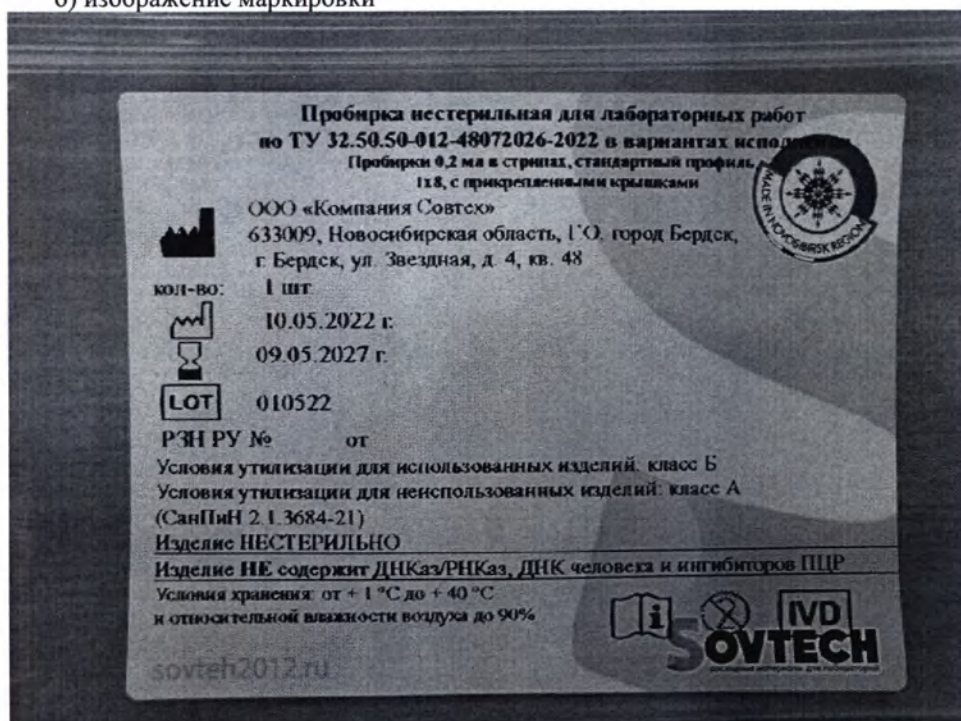


15. Пробирка 1,2 мл


а) изображение изделия

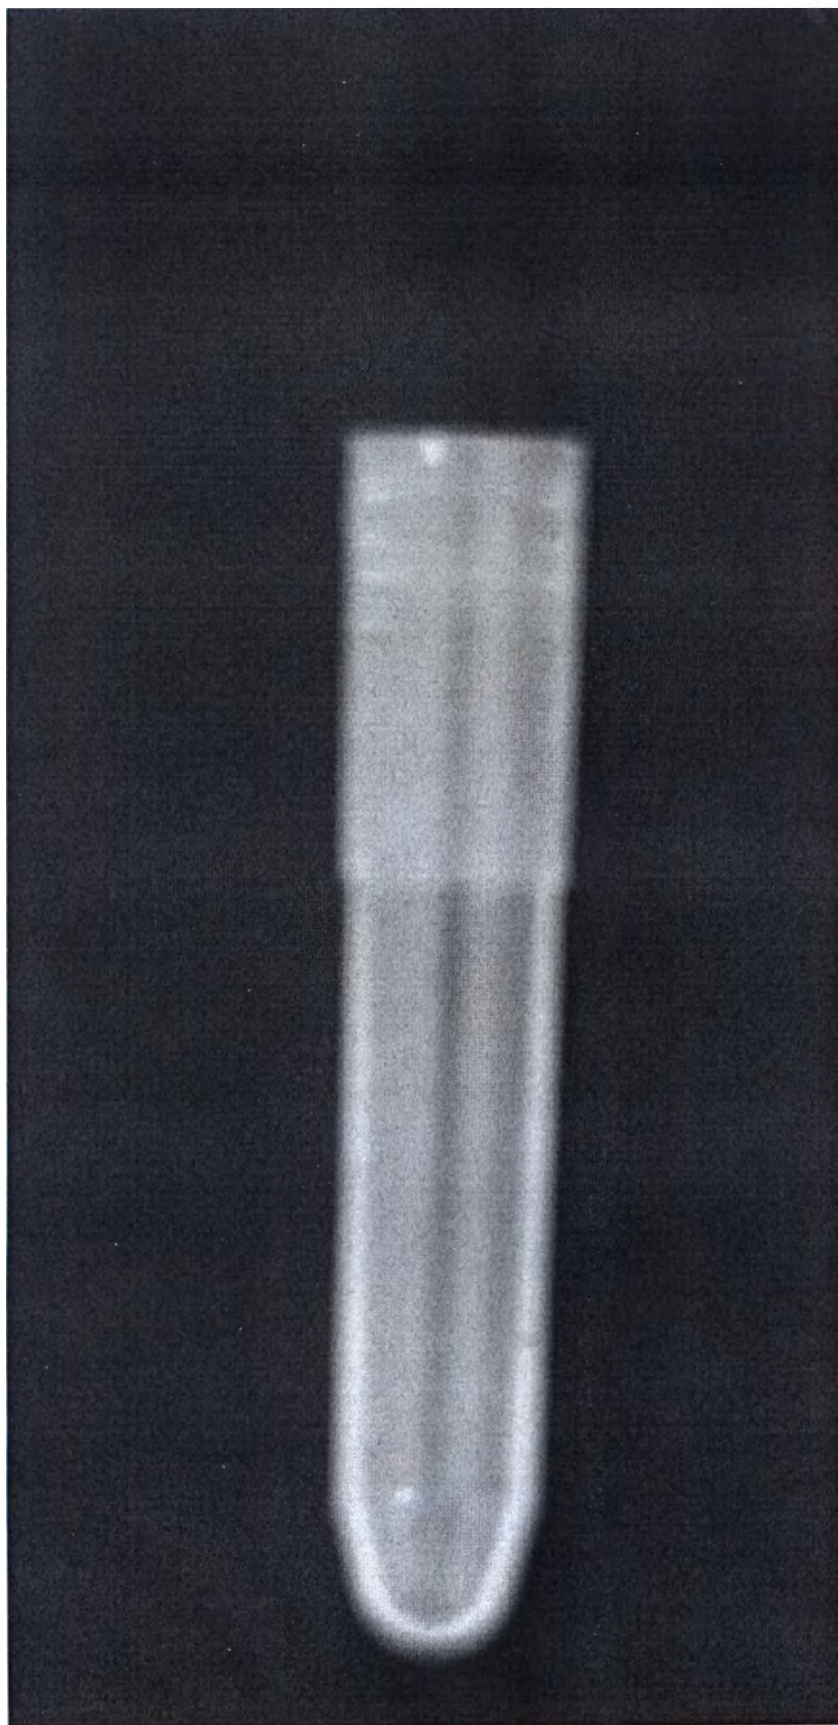


б) изображение маркировки

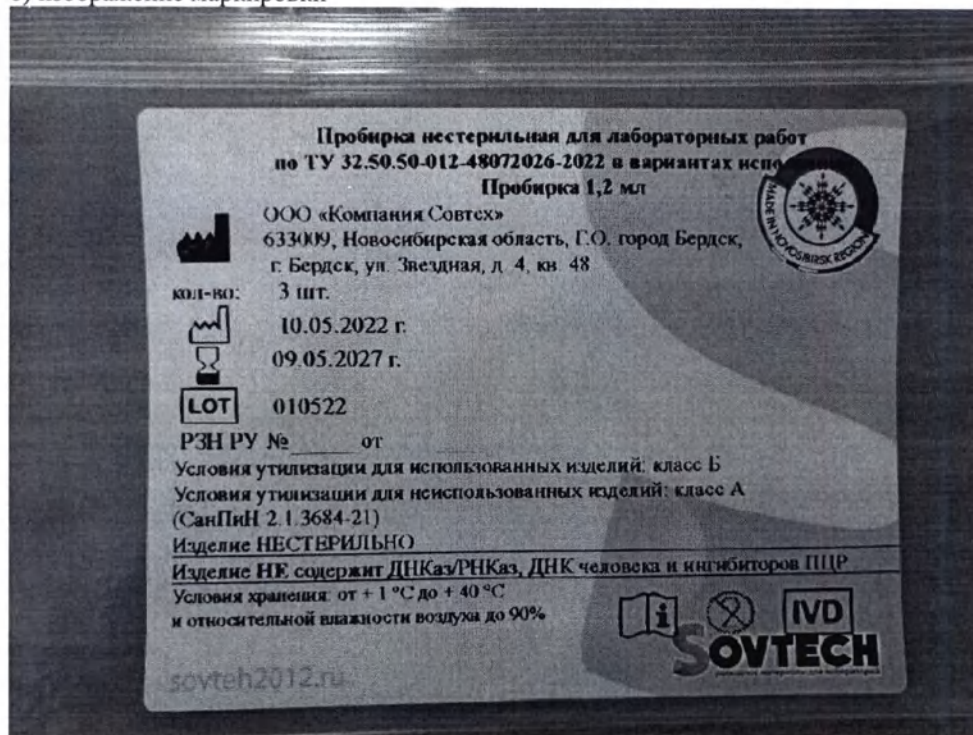

16. Пробирка 1,2 мл в стрипе на 8 пробирок
а) изображение изделия

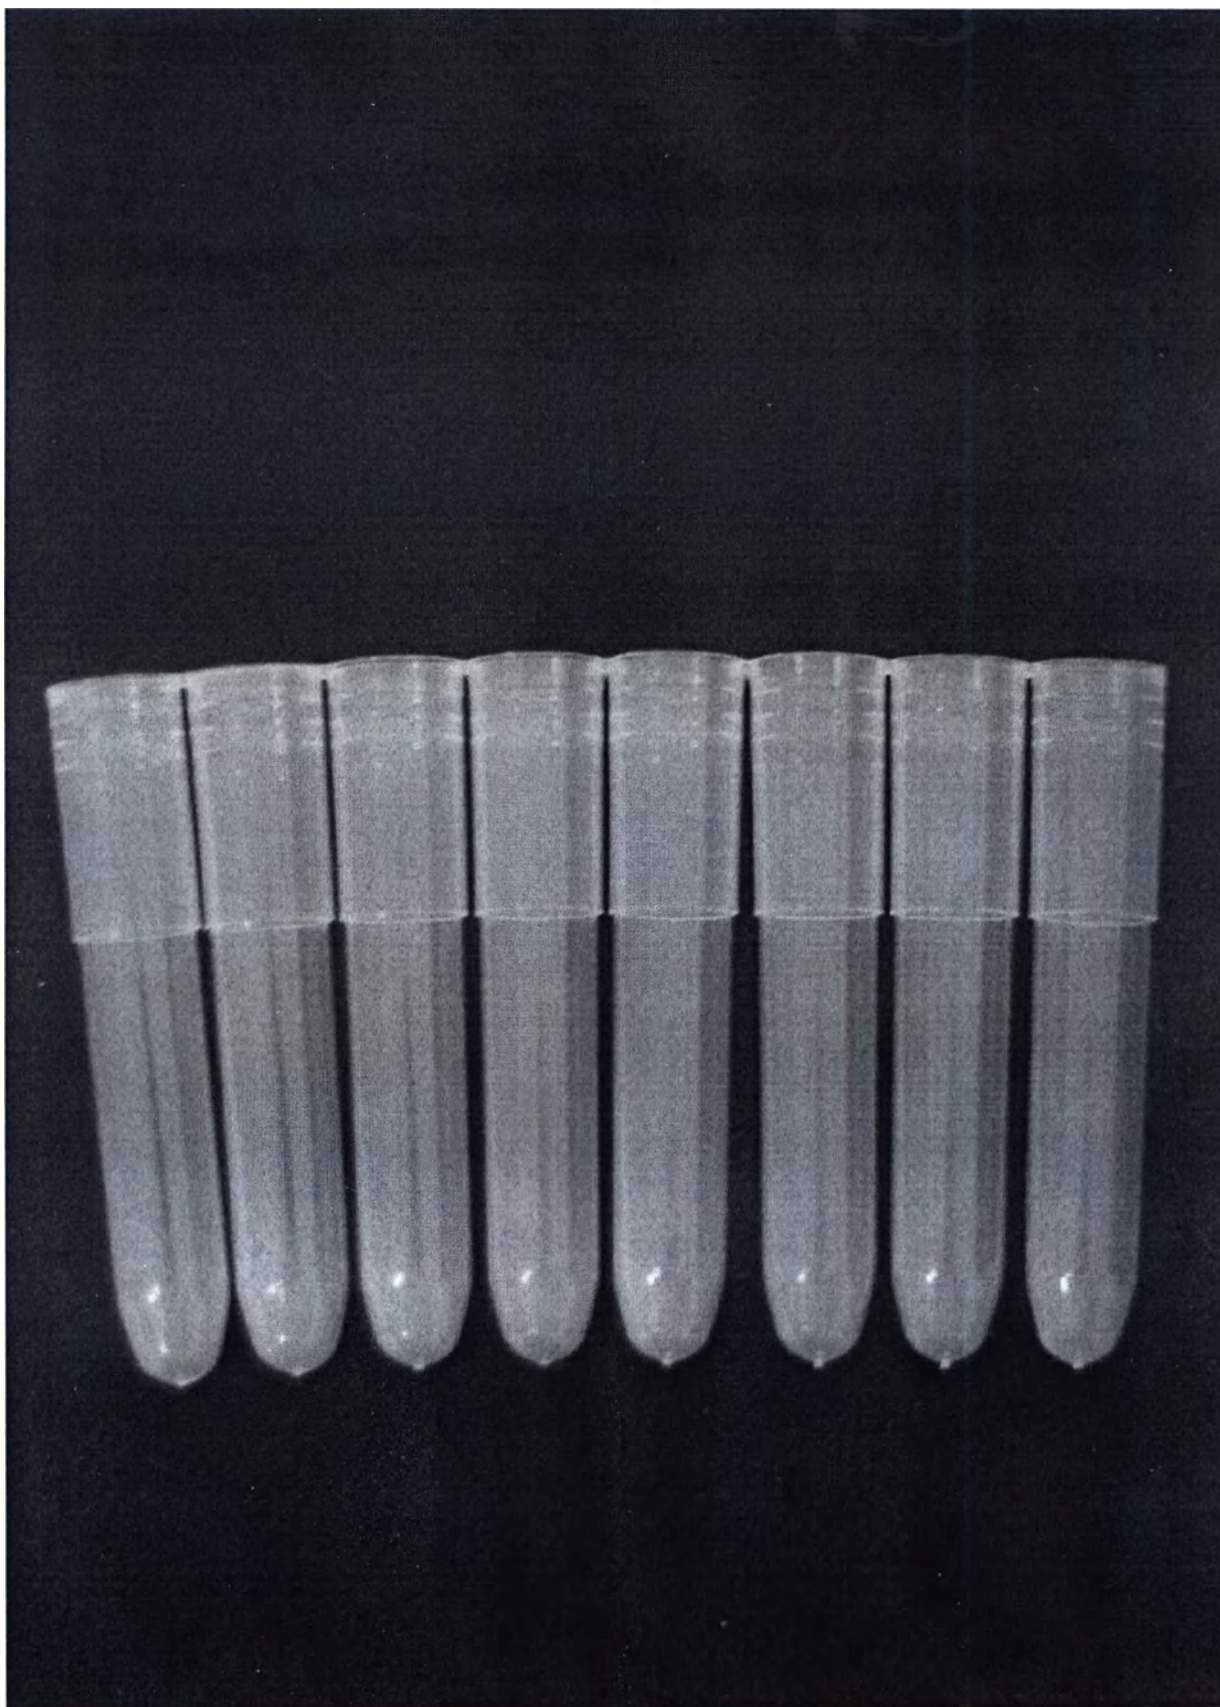


б) изображение маркировки

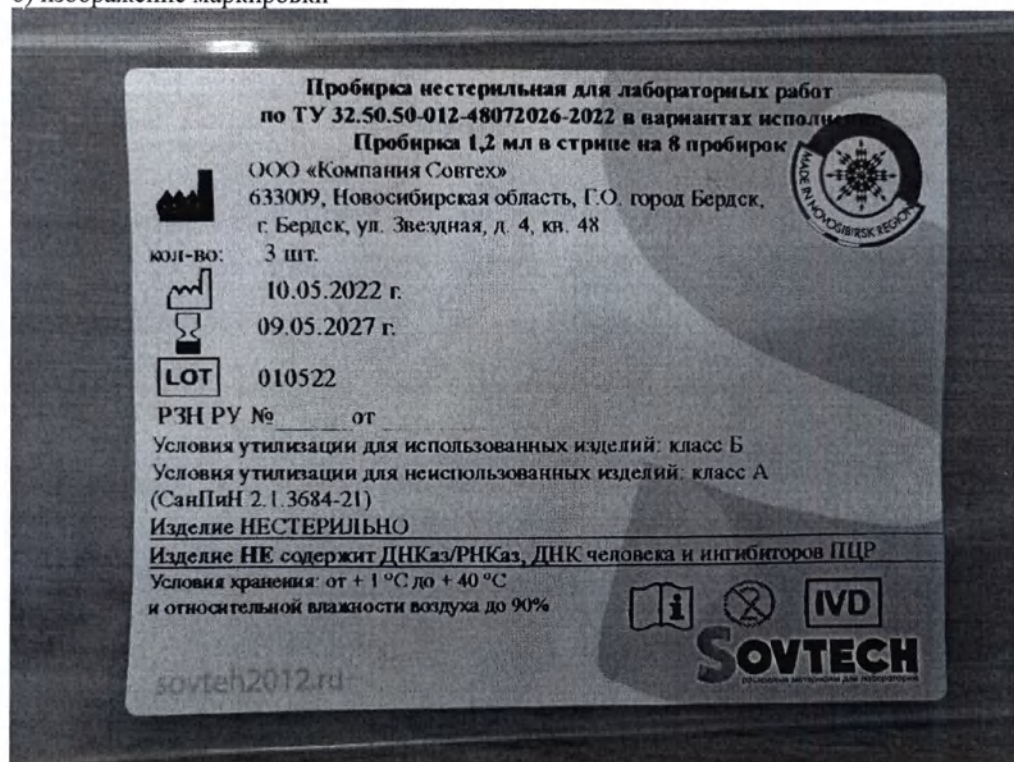

17. Пробирка 1,2 мл в стрипе на 12 пробирок

а) изображение изделия

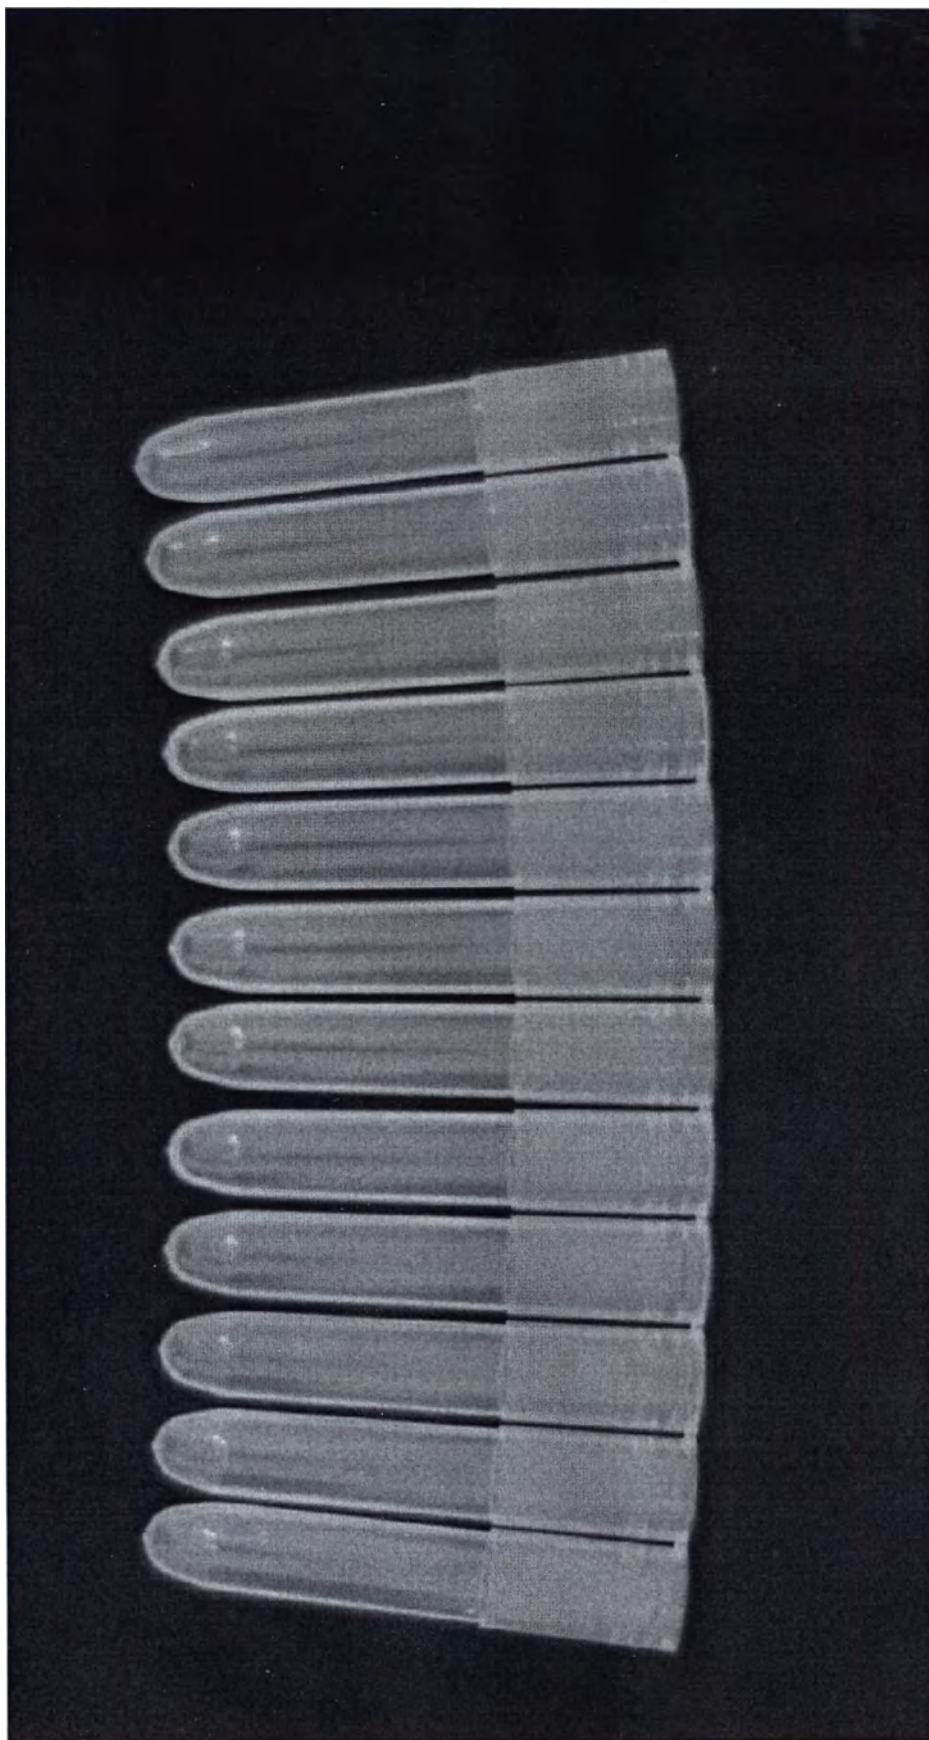


б) изображение маркировки



Принадлежности (при необходимости)

1. Колонка для выделения ДНК

а) изображение изделия

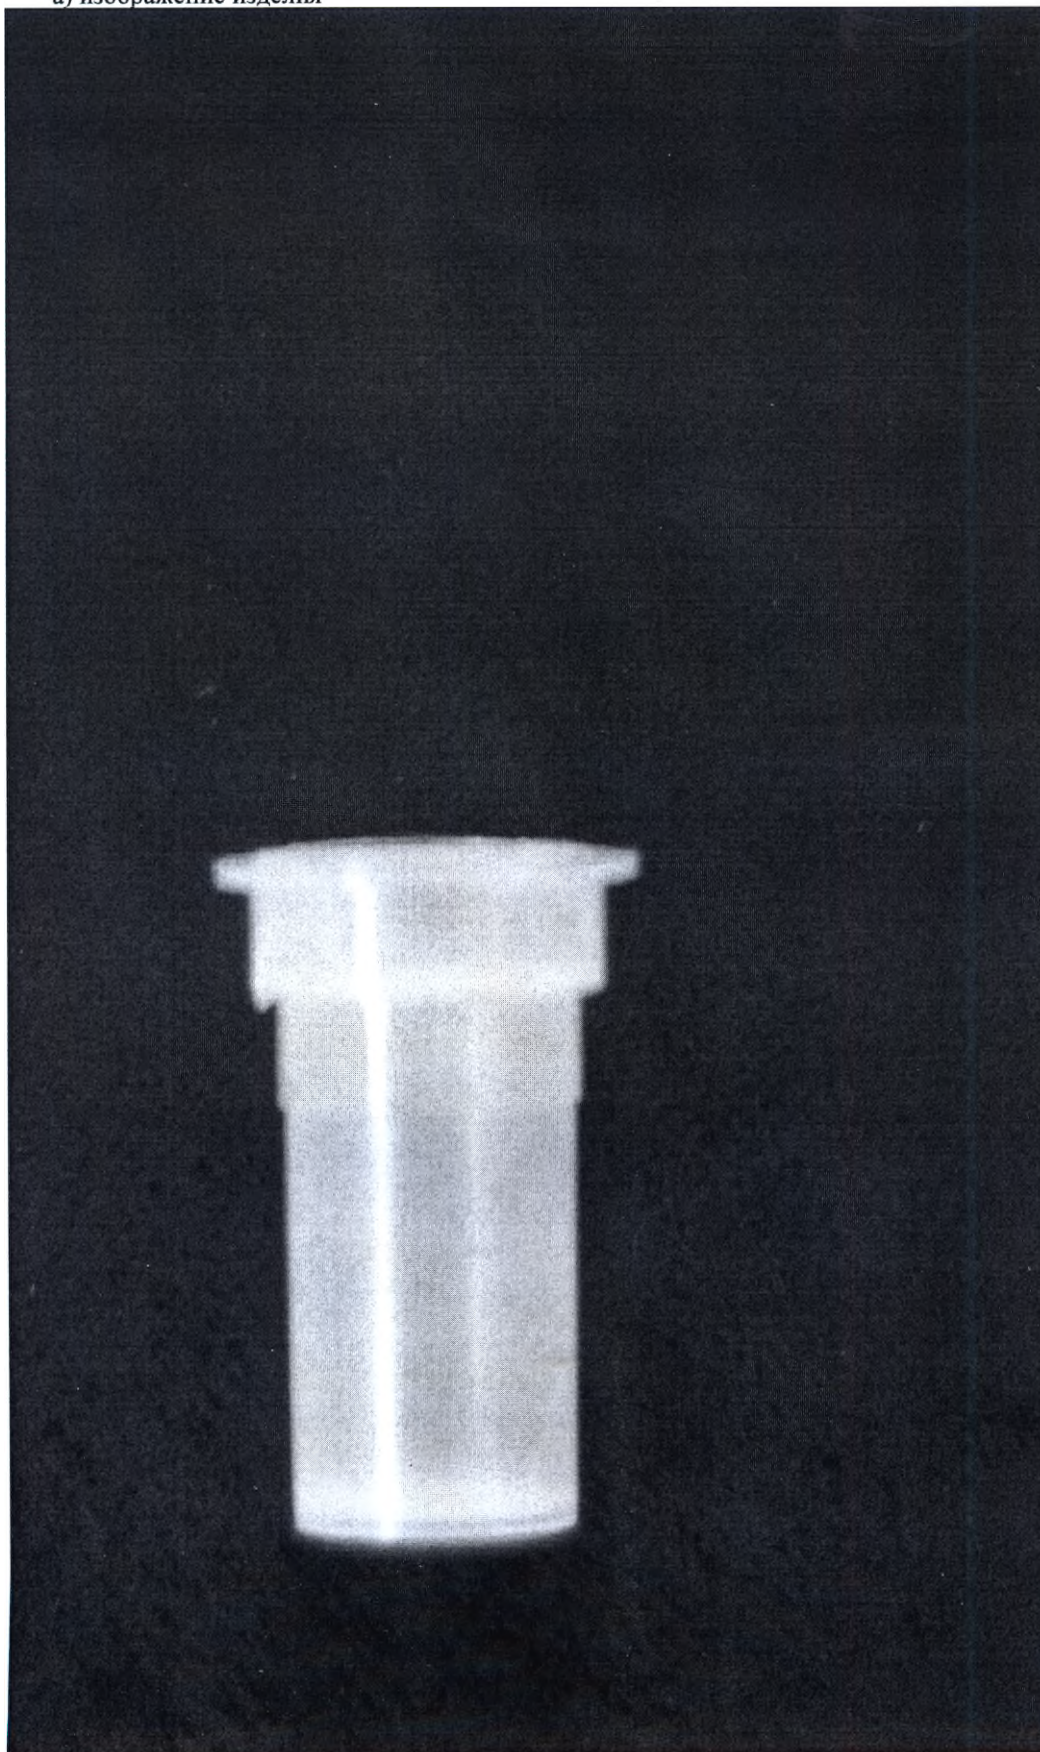


б) изображение маркировки



2. Крышка к Пробирке 0,1 мл

а) изображение изделия

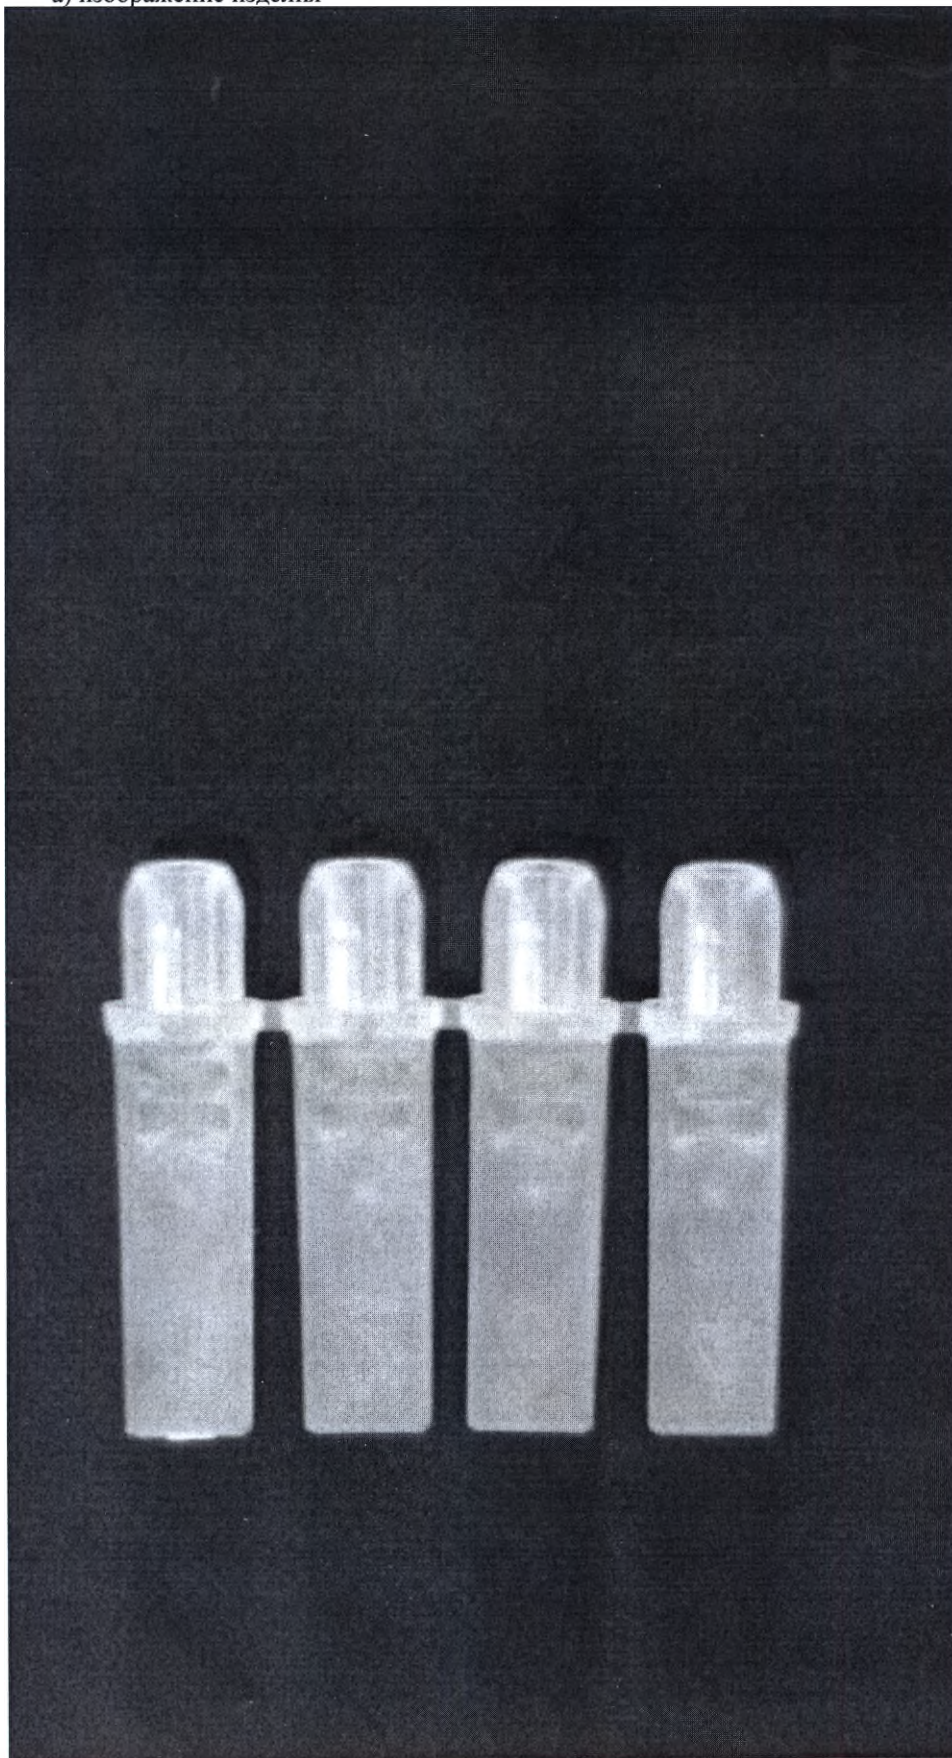


б) изображение маркировки




3. Крышка к стрипам плоская

а) изображение изделия

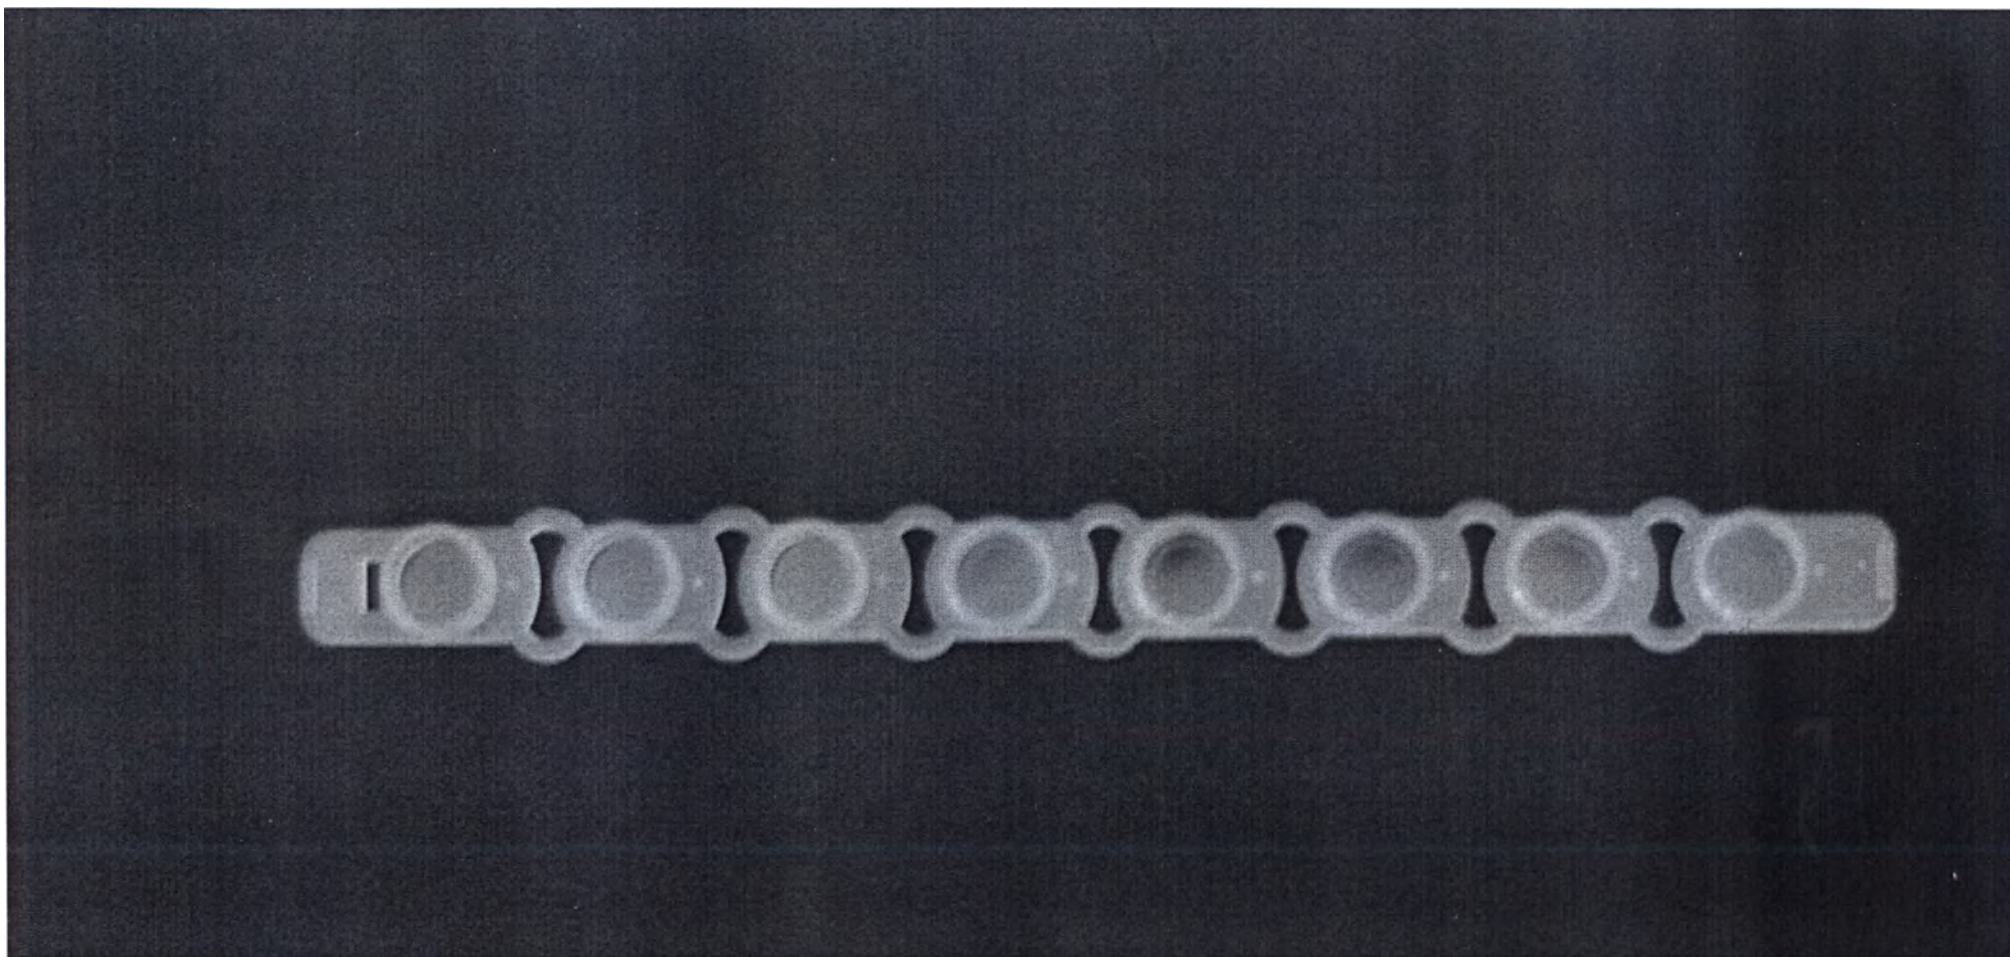


б) изображение маркировки

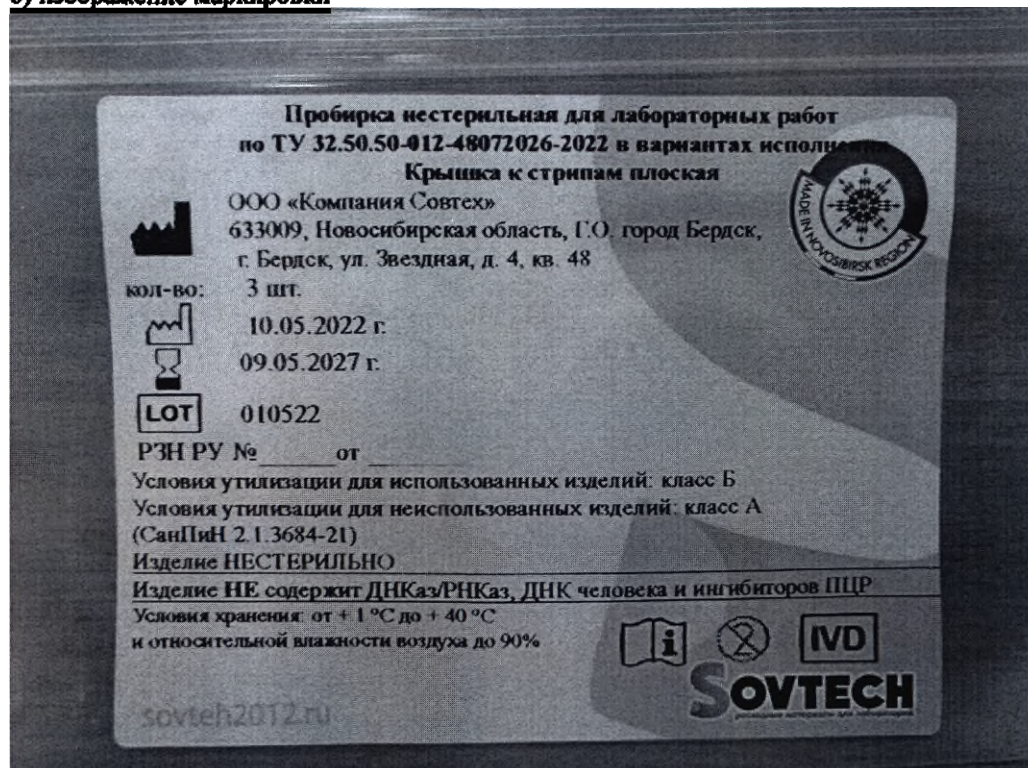


4. Крышка к стрипам выпуклая

а) изображение изделия

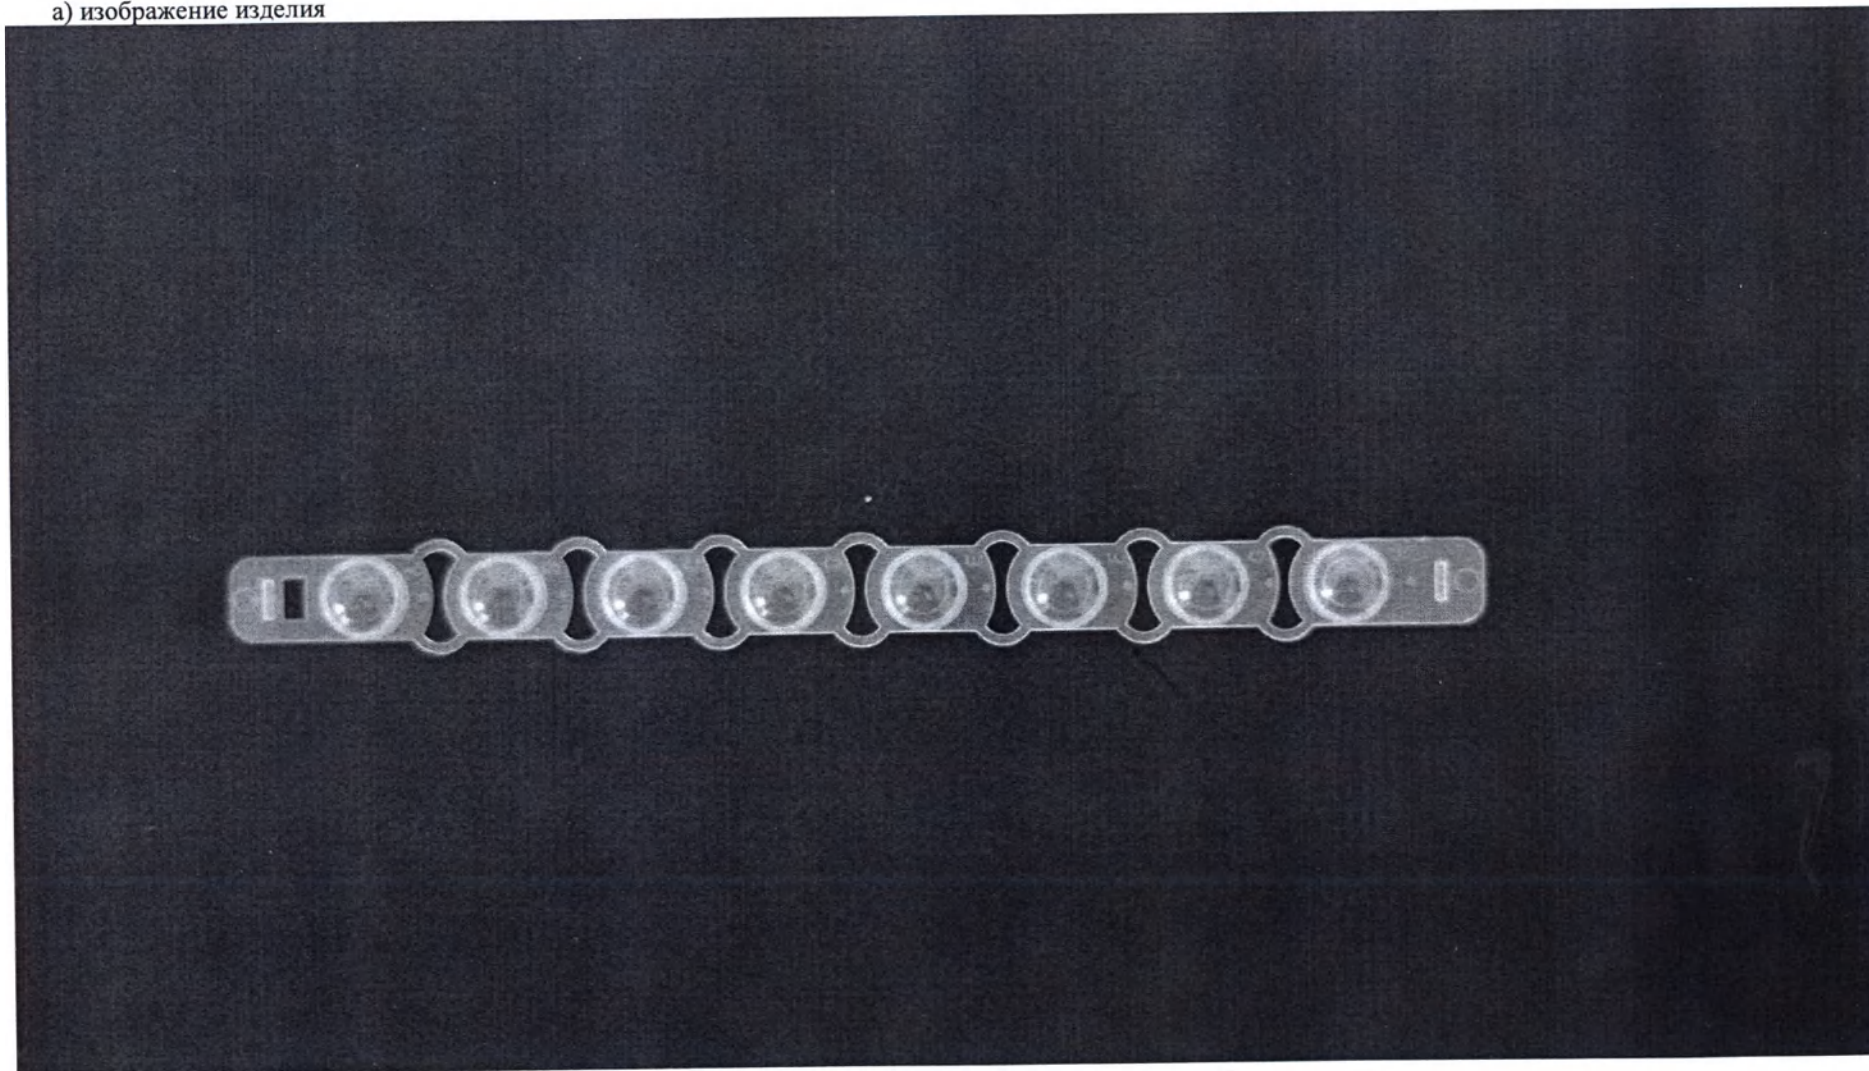

б) изображение маркировки

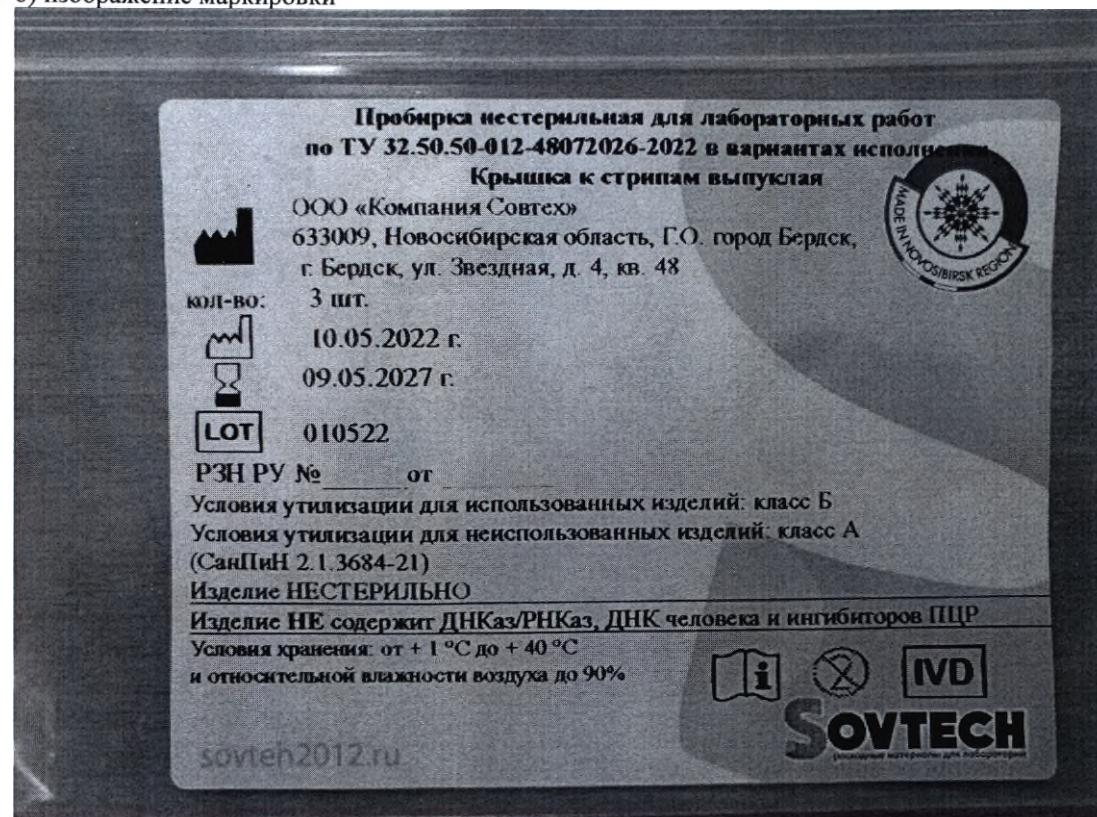

Пробирка нестерильная для лабораторных работ
по ТУ 32.50.50-012-48072026-2022 в вариантах исполнения

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область,
Г.О. город Бердск, г. Бердск,
ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 10.05.2022 г.

 09.05.2027 г.

 010522

Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

Условия транспортирования: От -50 °C до +50 °C
и относительной влажности воздуха до 95 %

Число единиц потребительской упаковки: 23 шт.

Масса нетто: 1320 г

Масса брутто: 1530 г

sovtech2012.ru

SOVTECH



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листа(ов)

Директор ООО «Компания Совтех»
Кондрашова О.Е.

