

**МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
МНТ-15 «POZIS»**



ОБЩИЙ ВИД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-15 «POZIS»

ВИД СЗАДИ

АВТОМАТ ВКЛ / ОТКЛ

РАЗЪЕМ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
МИКРОЛОГГЕРА



ЗНАК «ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!»



МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-15 «POZIS»

ВИД СЛЕВА



ВИД СПРАВА



МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
МНТ-30 «POZIS»



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩИЙ ВИД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ



МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-30 «POZIS»

ВИД СЗАДИ

ЗНАК «ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!»




МИКРОЛОГГЕРЫ

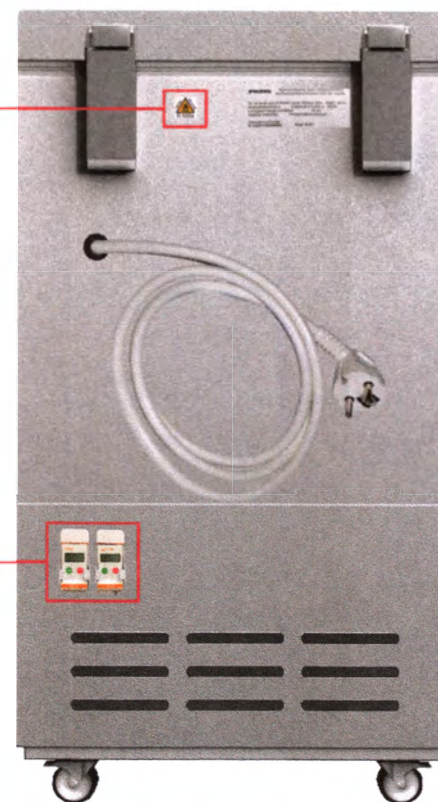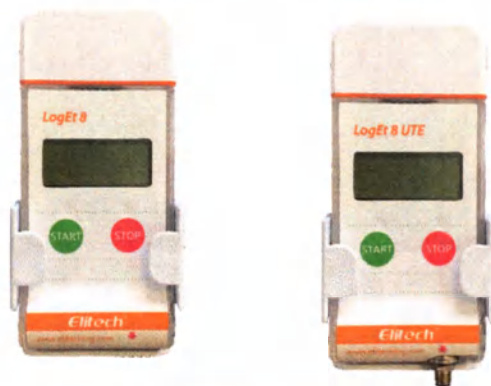


МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-30 «POZIS»

ВИД СЛЕВА

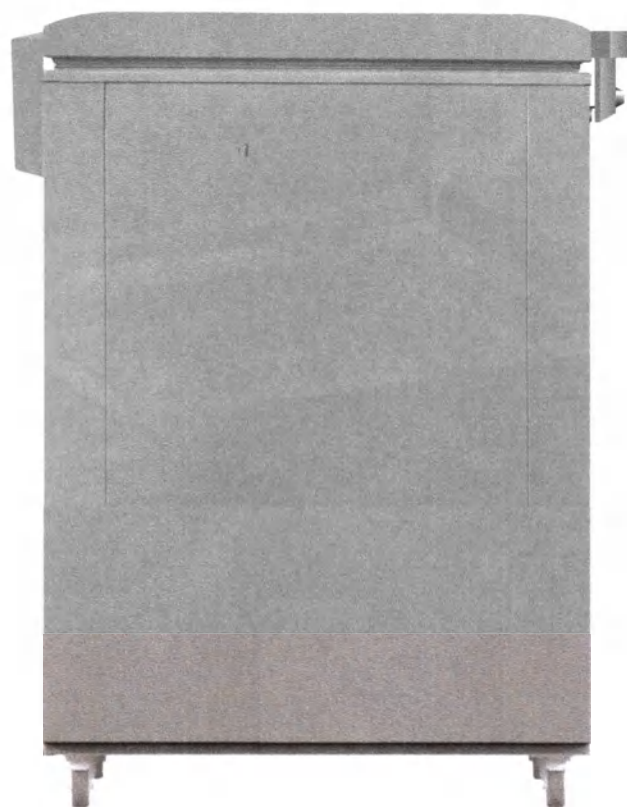

ВИД СПРАВА

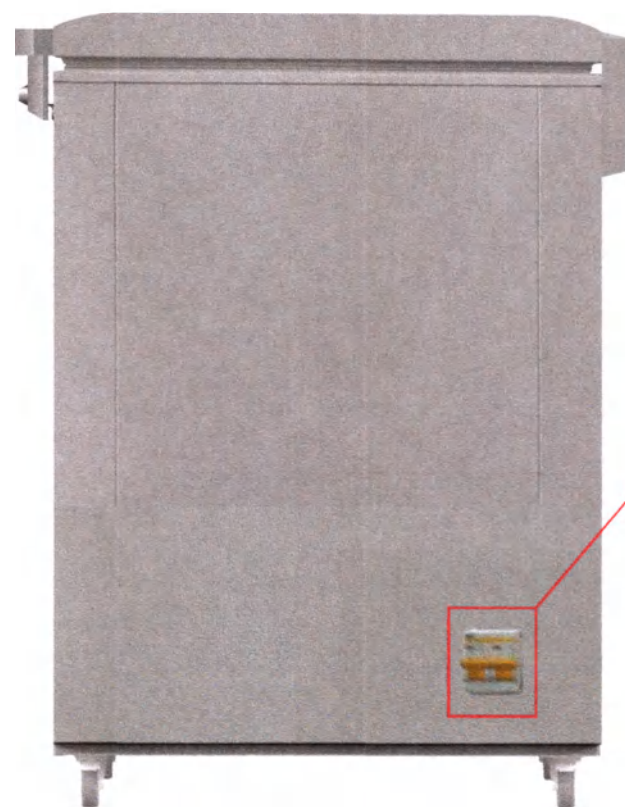

АВТОМАТ
ВКЛ / ОТКЛ

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-80 «POZIS»




БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩИЙ ВИД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-80 «POZIS»

ВИД СЗАДИ

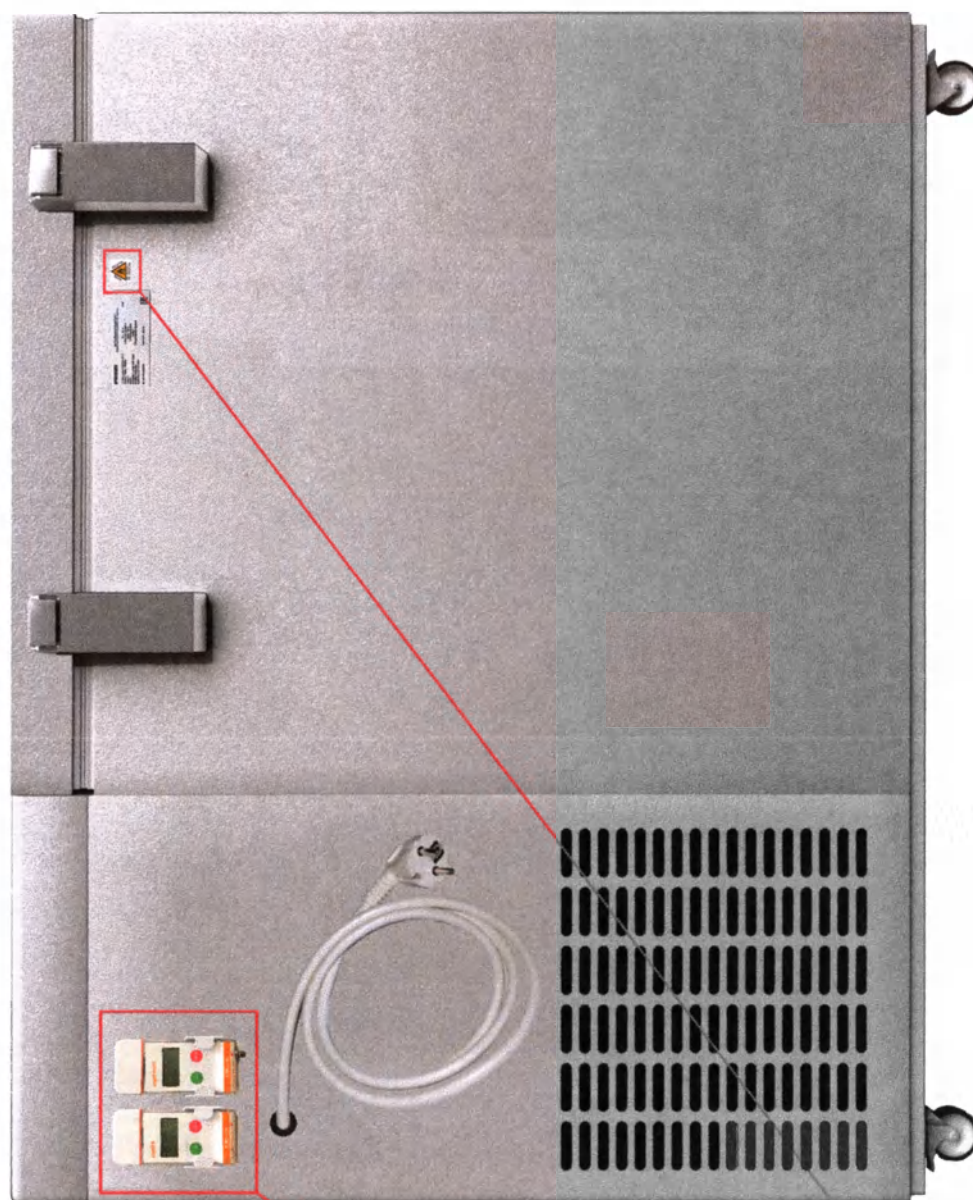

МИКРОЛОГГЕРЫ




ЗНАК «ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!»




МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-80 «POZIS»


ВИД СЛЕВА

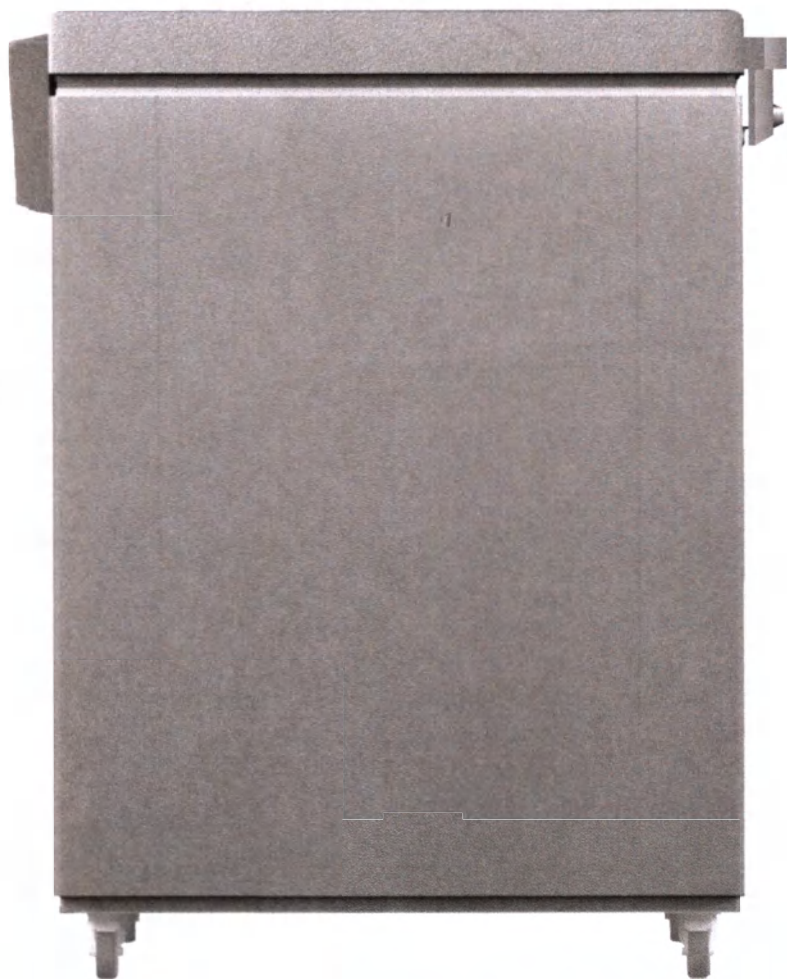


ВИД СПРАВА

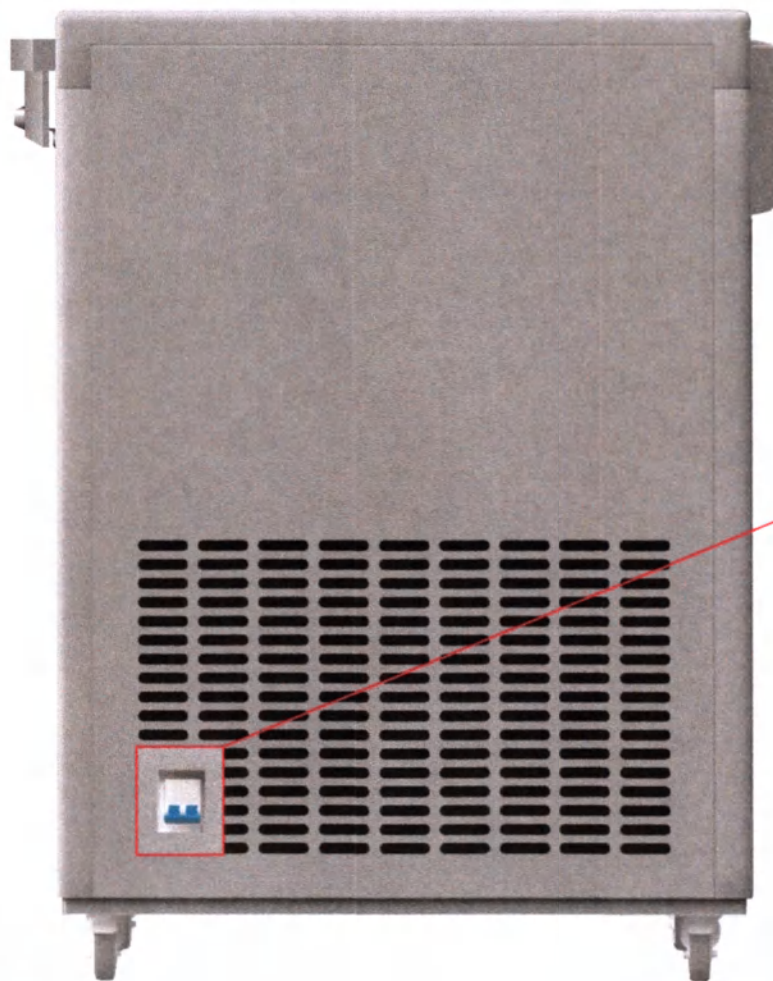

АВТОМАТ ВКЛ/ОТКЛ

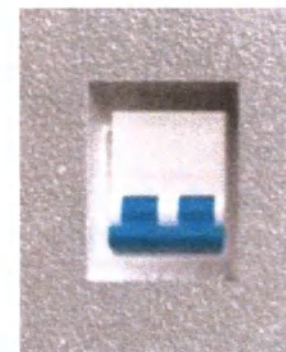

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-180 «POZIS»

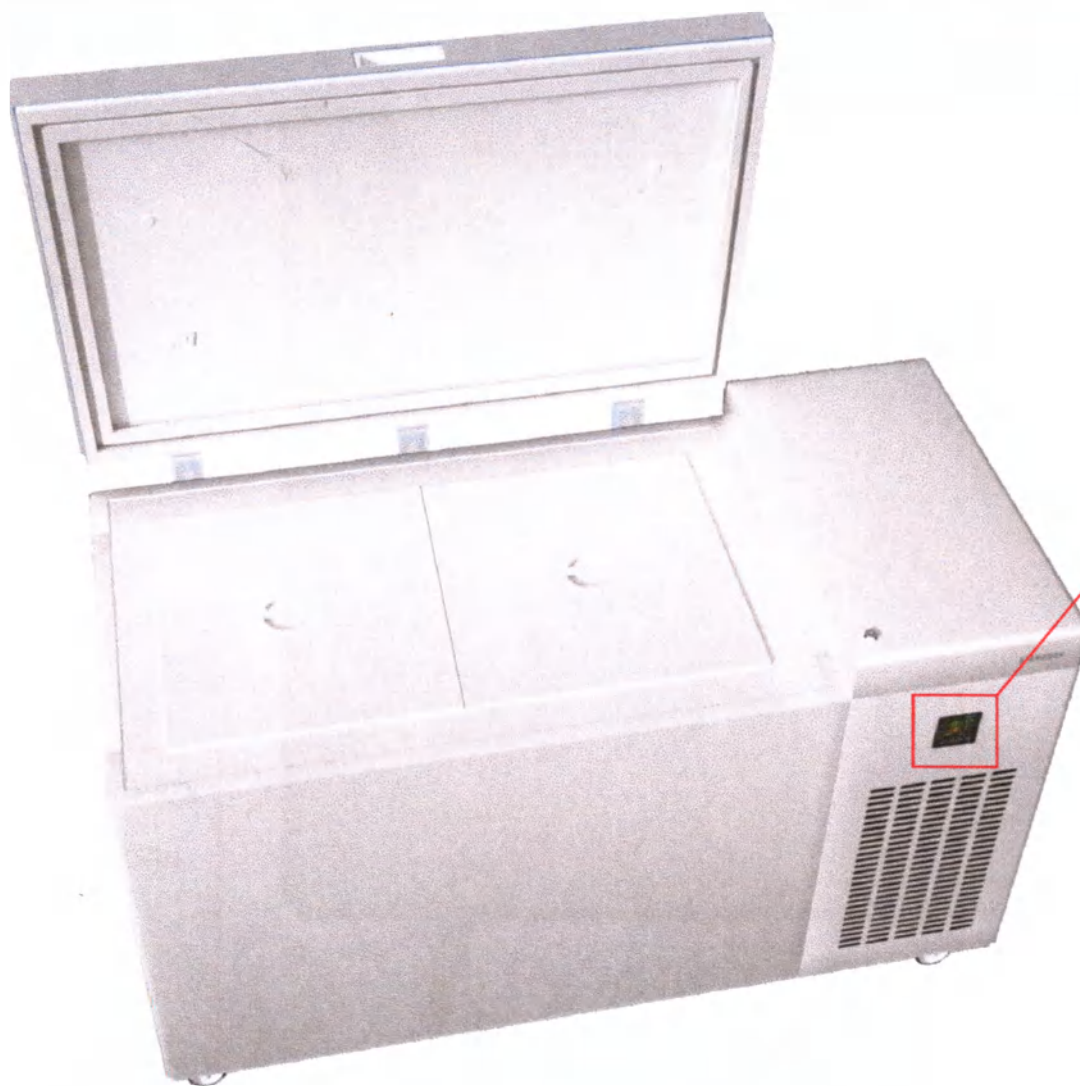


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩИЙ ВИД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-180 «POZIS»

ВИД СЗАДИ

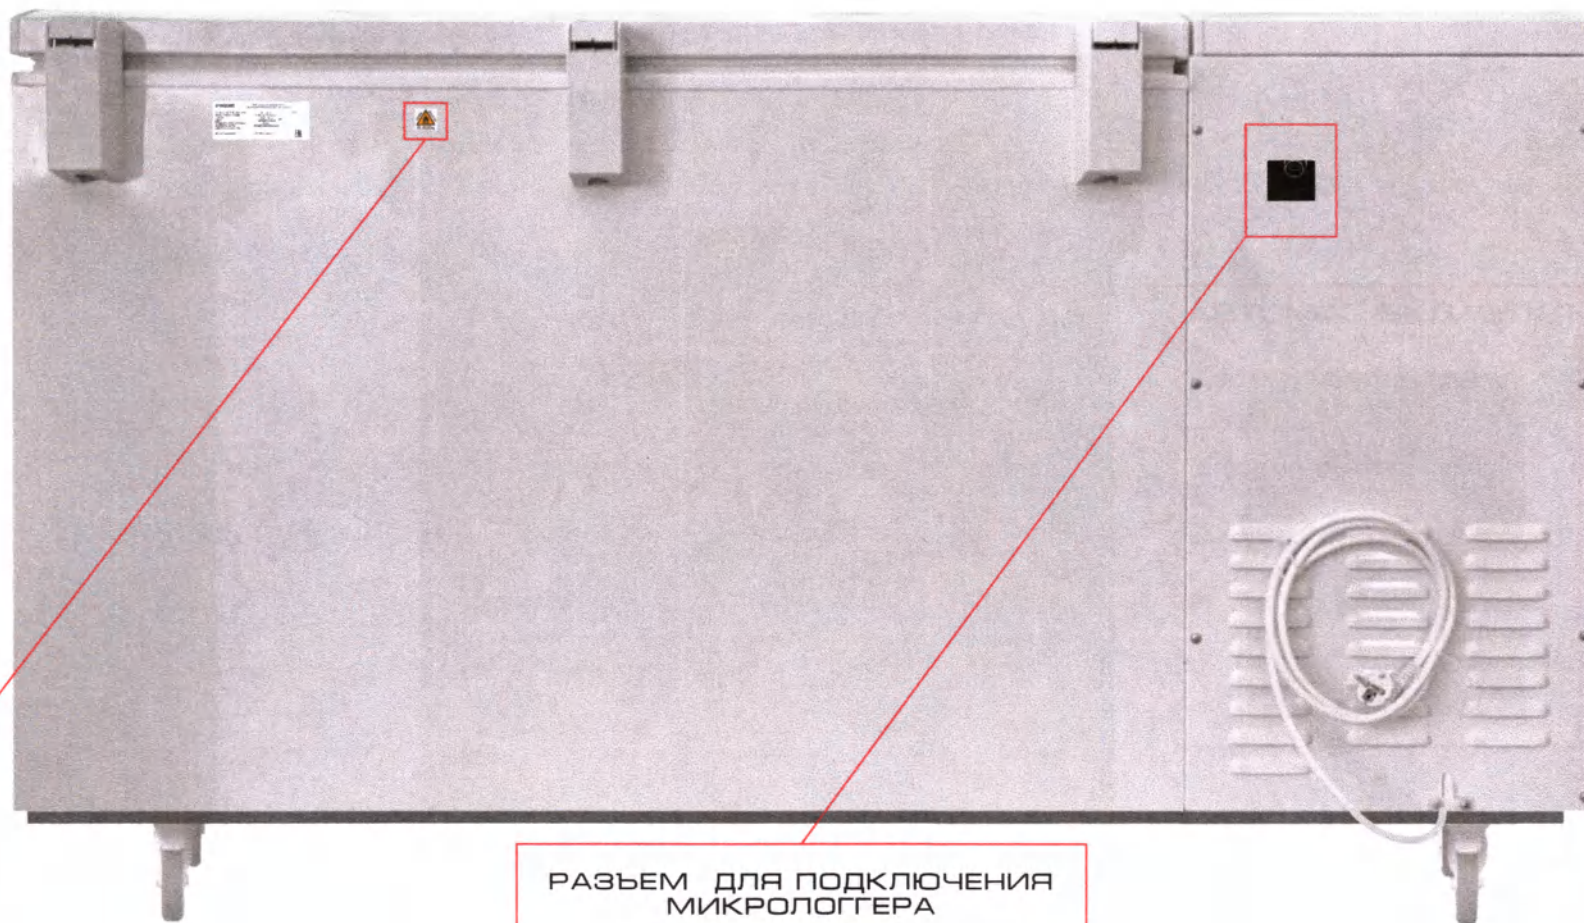

ЗНАК «ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!»



РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
МИКРОЛОГГЕРА




МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
МНТ-180 «POZIS»


ВИД СЛЕВА



ВИД СПРАВА

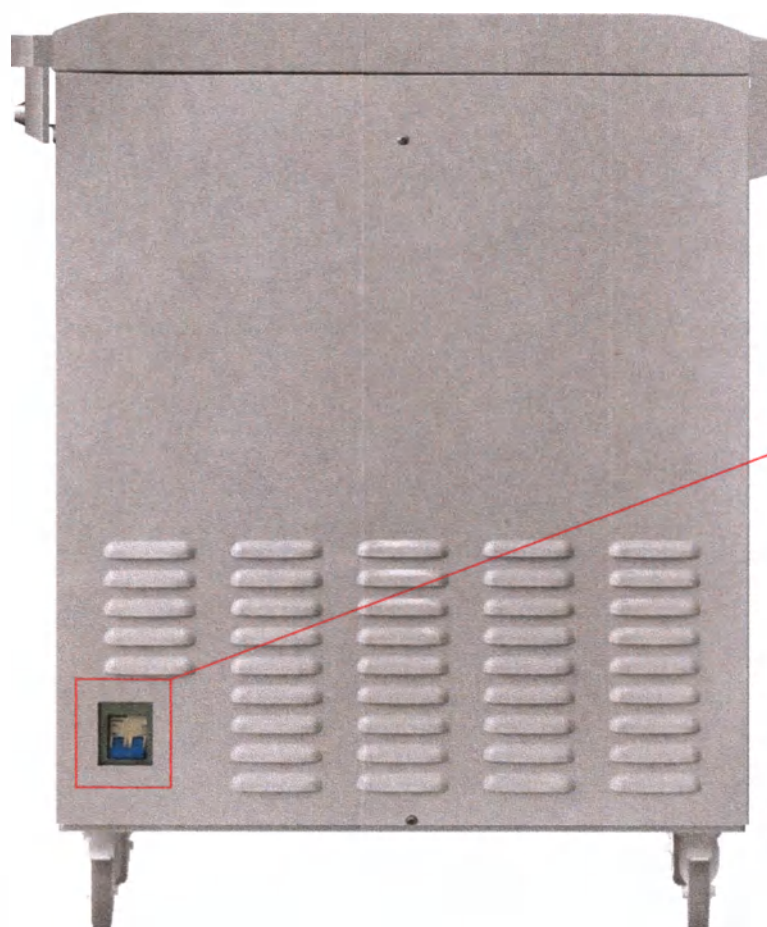


АВТОМАТ ВКЛ/ОТКЛ

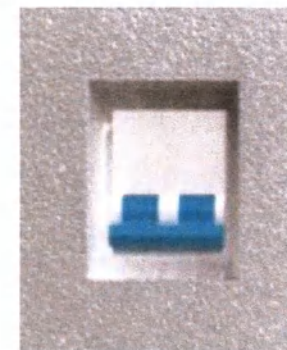

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-200 «POZIS»


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

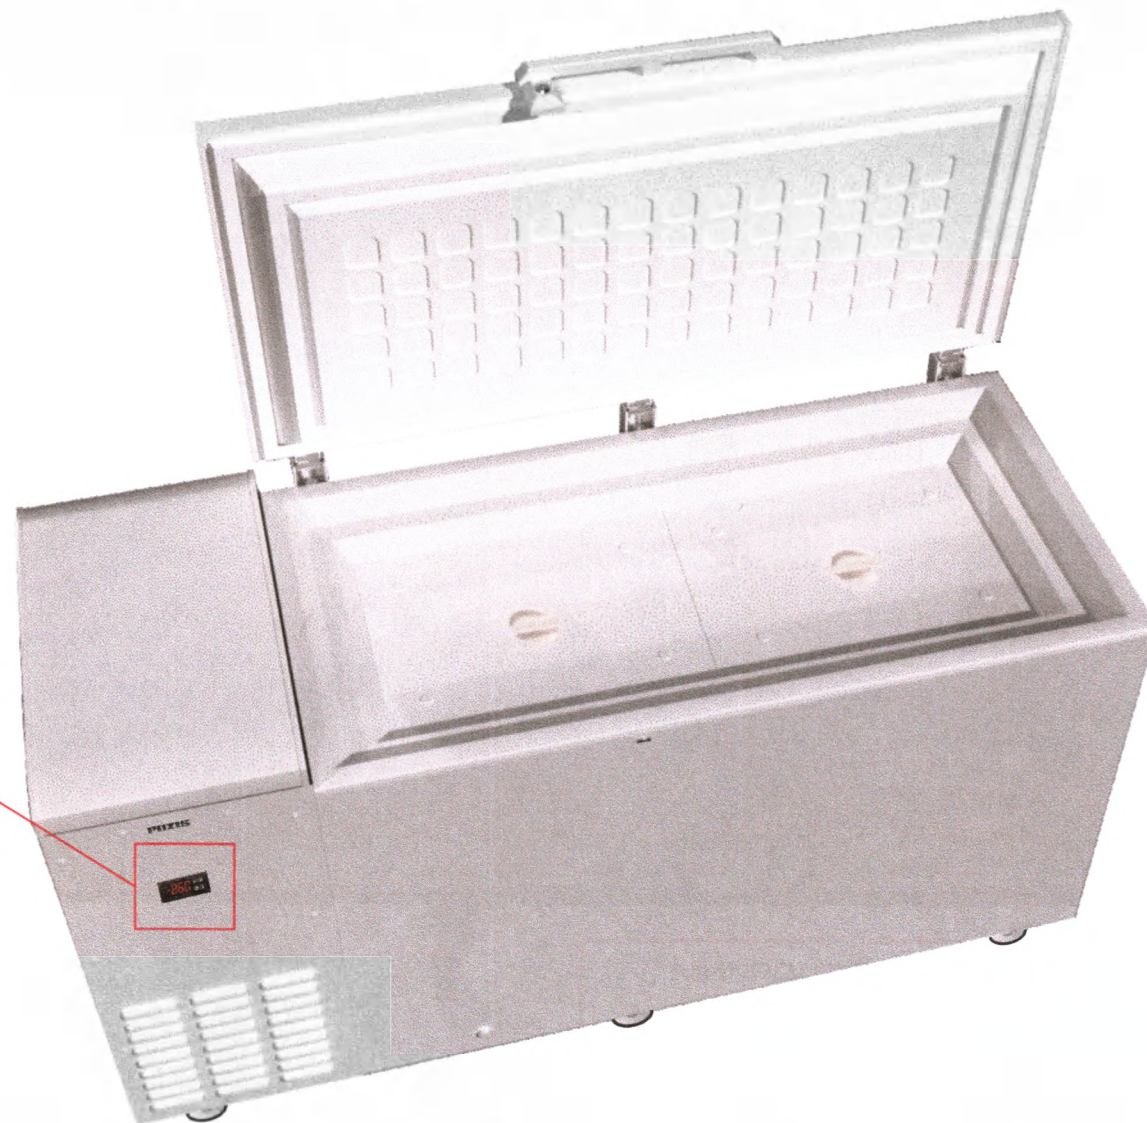

ОБЩИЙ ВИД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-200 «POZIS»

ВИД СЗАДИ

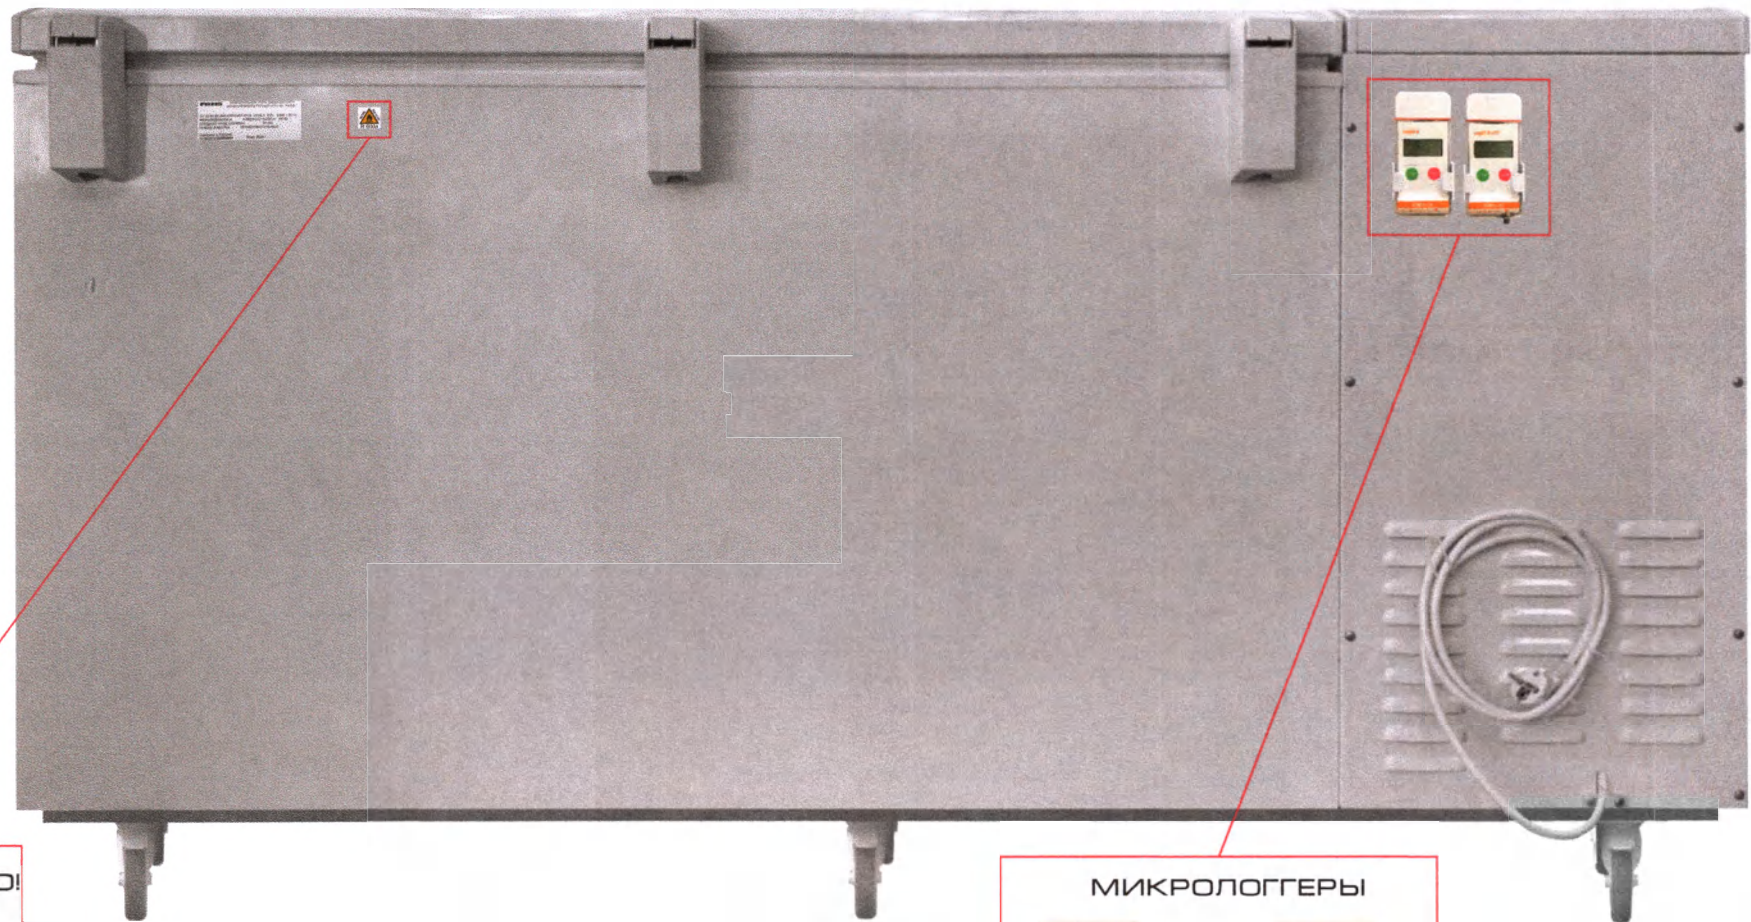

ЗНАК «ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!»



МИКРОЛОГГЕРЫ




МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-200 «POZIS»


ВИД СЛЕВА



ВИД СПРАВА

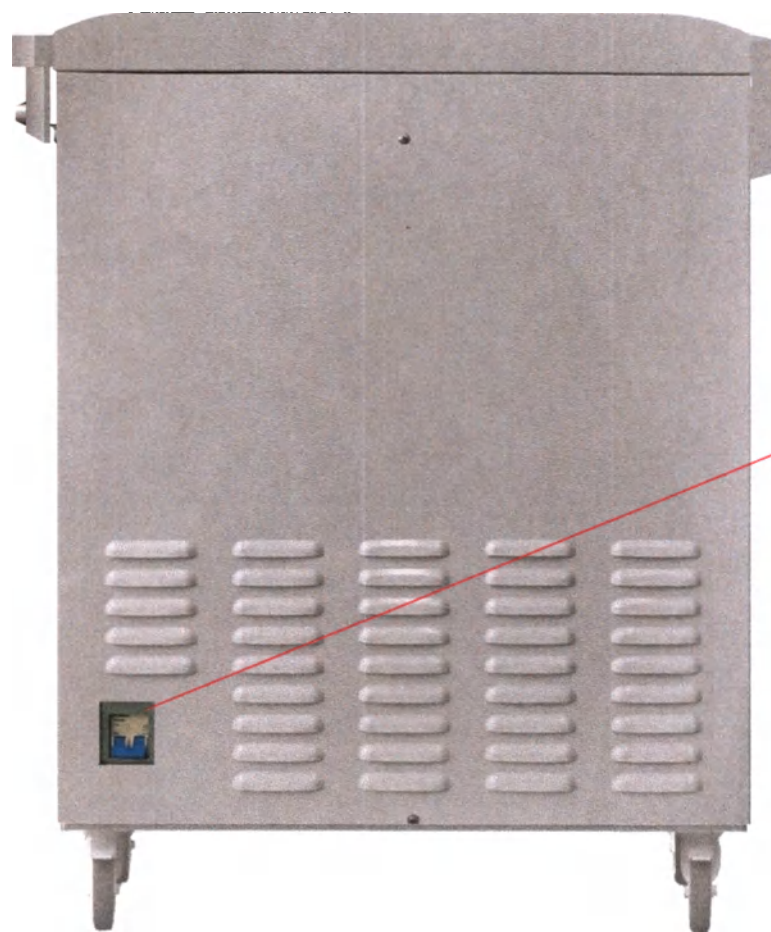

АВТОМАТ ВКЛ/ОТКЛ

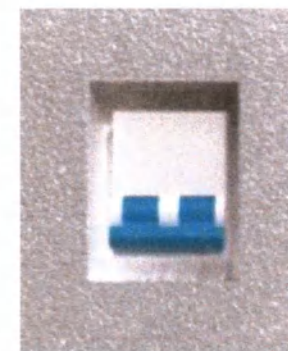


МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-300 «POZIS»



ОБЩИЙ ВИД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-300 «POZIS»


ВИД СЗАДИ

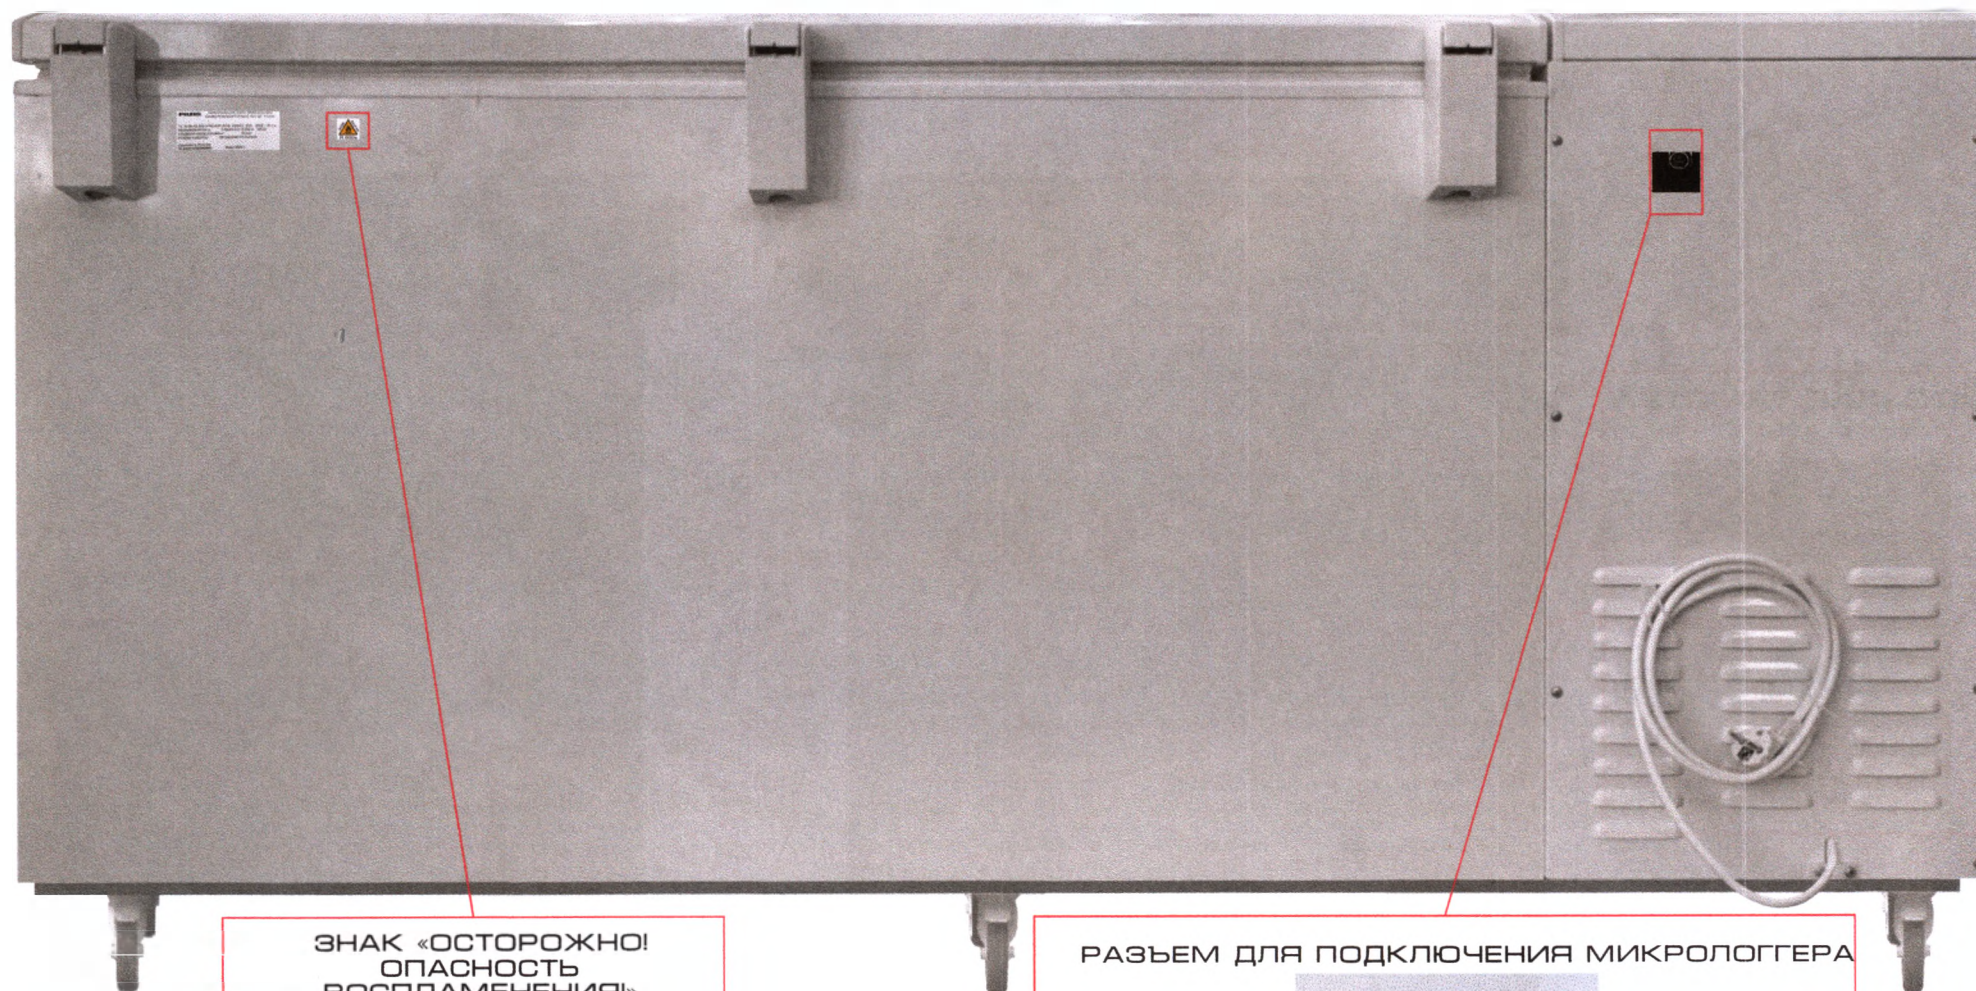

ЗНАК «ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!»




РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОЛОГГЕРА

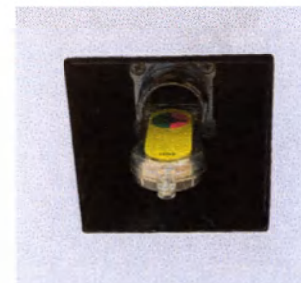


МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНТ-300 «POZIS»


ВИД СЛЕВА

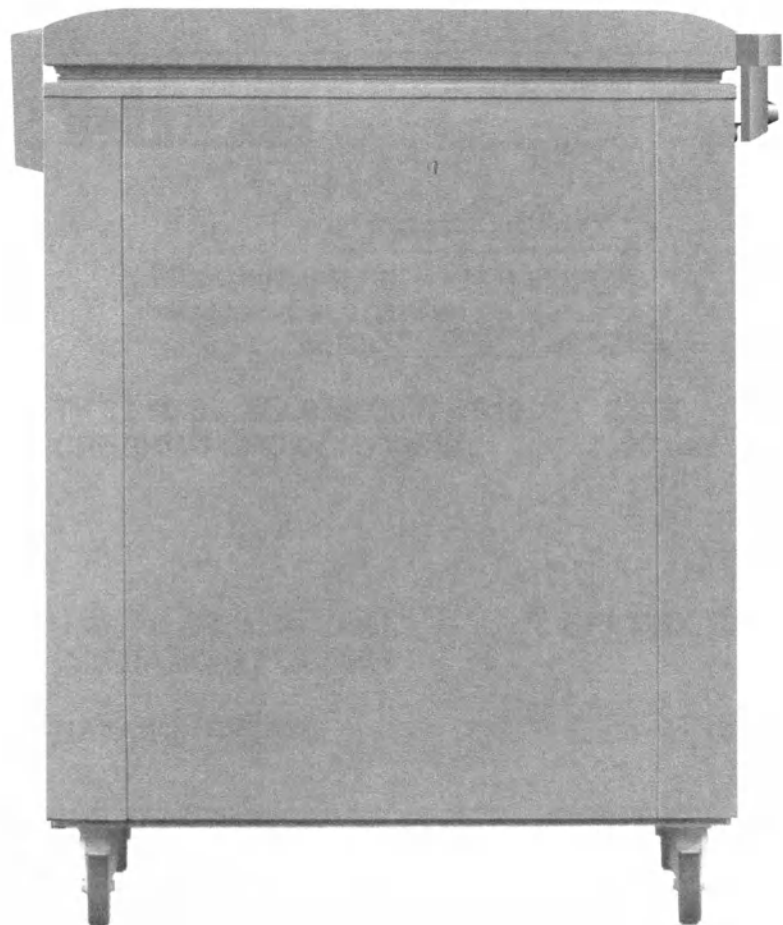

ВИД СПРАВА

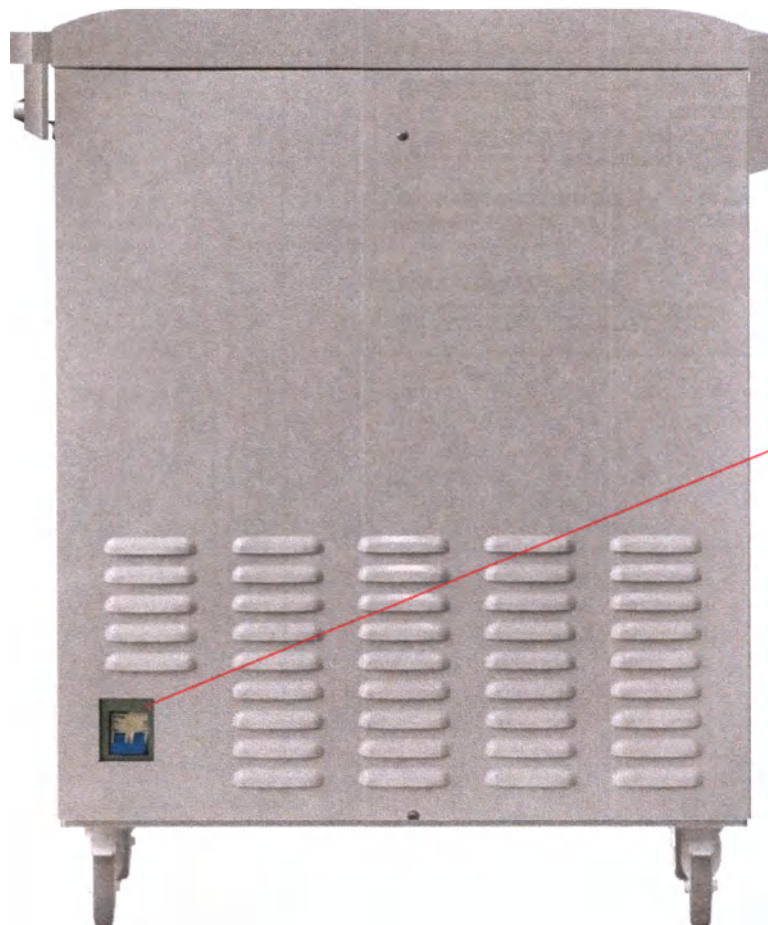

АВТОМАТ ВКЛ/ОТКЛ

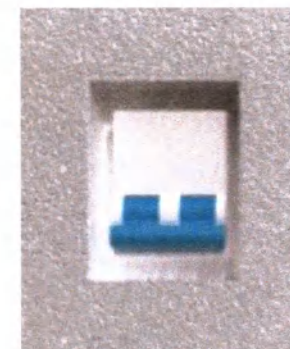

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МОРОЗИЛЬНИКОВ-ЛАРЕЙ МЕДИЦИНСКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МНТ-15 «POZIS», МНТ-30 «POZIS», МНТ-80 «POZIS», МНТ-180 «POZIS» МНТ-200 «POZIS», МНТ-300 «POZIS»

МАРКИРОВКА (ЯРЛЫК) ГОФРОКОРОБА


POZIS Утвержденный тип упаковки и маркировки для медицинских морозильников МНТ-15 Морозильник-ларь медицинский низкотемпературный МНТ- «POZIS» ТУ 32.50.50-222-07503307-2019 230В ~ 50Гц СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ: 10 лет Длина упаковки x Ширина упаковки x Высота упаковки см БРУТТО Масса нетто кг СДЕЛАНО В РОССИИ ДАТА ВЫПУСКА Масса нетто 20 г.	«POZIS» МНТ- XXXXXXXXXX
---	--

МАРКИРОВКА МОРОЗИЛЬНИКА


POZIS		Морозильник-ларь медицинский низкотемпературный МНТ- «POZIS»	
ТУ 32.50.50-222-07503307-2019		УХП 4.2	
Объемная упаковка 	Брутто кг	Масса нетто кг	Вт 230В ~ 50Гц
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ		10 лет	
РЕЖИМ РАБОТЫ		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	
СДЕЛАНО В РОССИИ			
№ 		Масса нетто 20 г.	

ФОТООБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ
МОРОЗИЛЬНИКОВ-ЛАРЕЙ МЕДИЦИНСКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
МНТ-15 «POZIS», МНТ-30 «POZIS», МНТ-80 «POZIS», МНТ-180 «POZIS»
МНТ-200 «POZIS», МНТ-300 «POZIS»

МАРКИРОВКА (ЯРЛЫК) ГОФРОКОРОБА

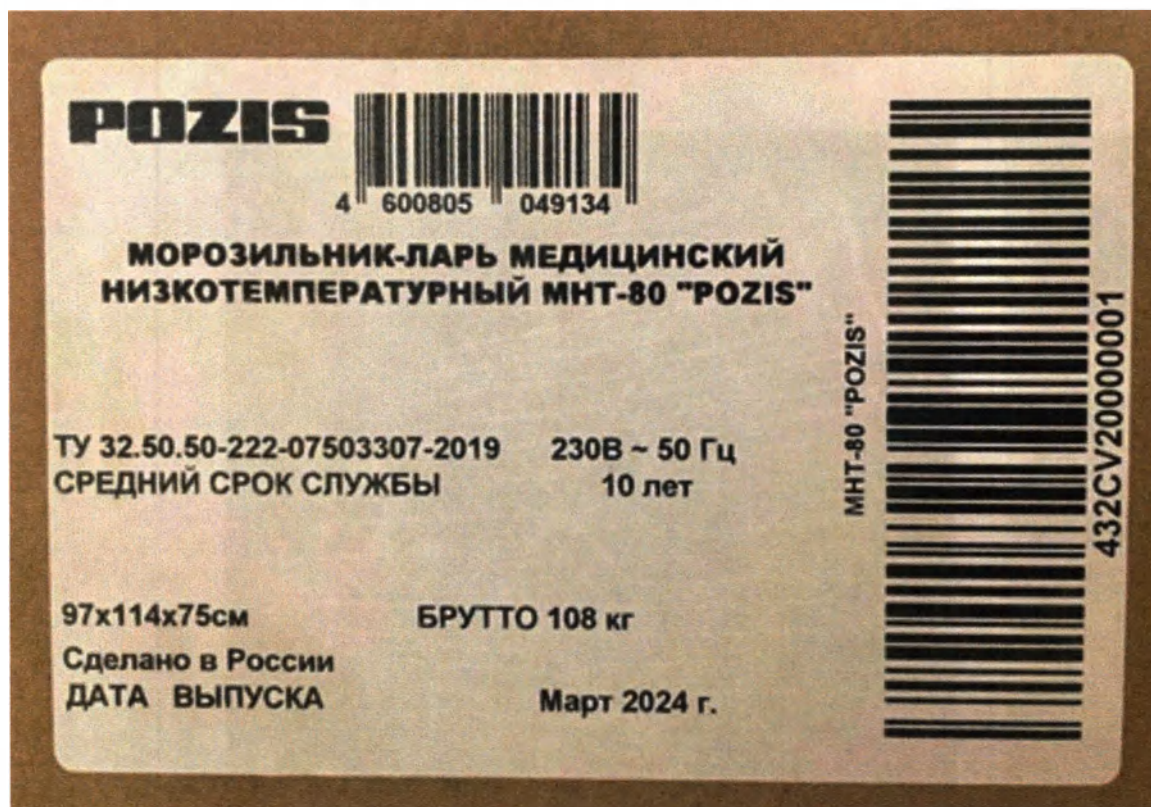


МАРКИРОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

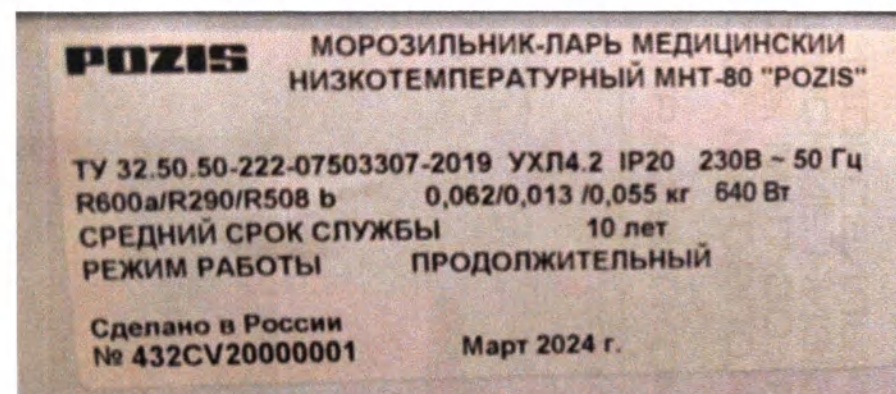


**МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ
МЕДИЦИНСКИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
МНТ-15 «POZIS», МНТ-30 «POZIS», МНТ-80 «POZIS»,
МНТ-180 «POZIS», МНТ-200 «POZIS», МНТ-300 «POZIS»**

ФОТОГРАФИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

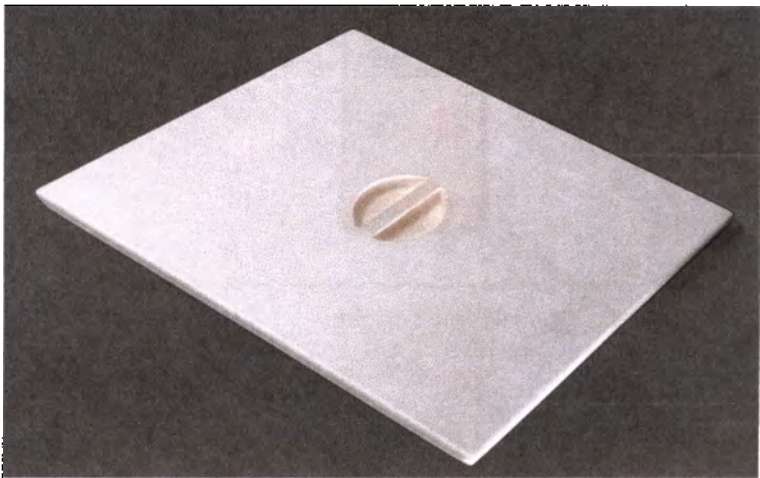НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО	ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
КЛЮЧ	
КРЫШКА	
КОРЗИНА (ОПЦИОНАЛЬНО)	


НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО	ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МИКРОЛОГГЕР (ОПЦИОНАЛЬНО) DLT - 01 - РТ	
МИКРОЛОГГЕР LOGET 8 UTE (ОПЦИОНАЛЬНО)	
МИКРОЛОГГЕР LOGET 8 (ОПЦИОНАЛЬНО)	
КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ МИКРОЛОГГЕРА (ОПЦИОНАЛЬНО)	
ВИНТ (ОПЦИОНАЛЬНО)	

МАКЕТ УПАКОВКИ МОРОЗИЛЬНИКОВ-ЛАРЕЙ МЕДИЦИНСКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МНТ-15 «POZIS», МНТ-80 «POZIS», МНТ-180 «POZIS», МНТ-200 «POZIS», МНТ-300 «POZIS»

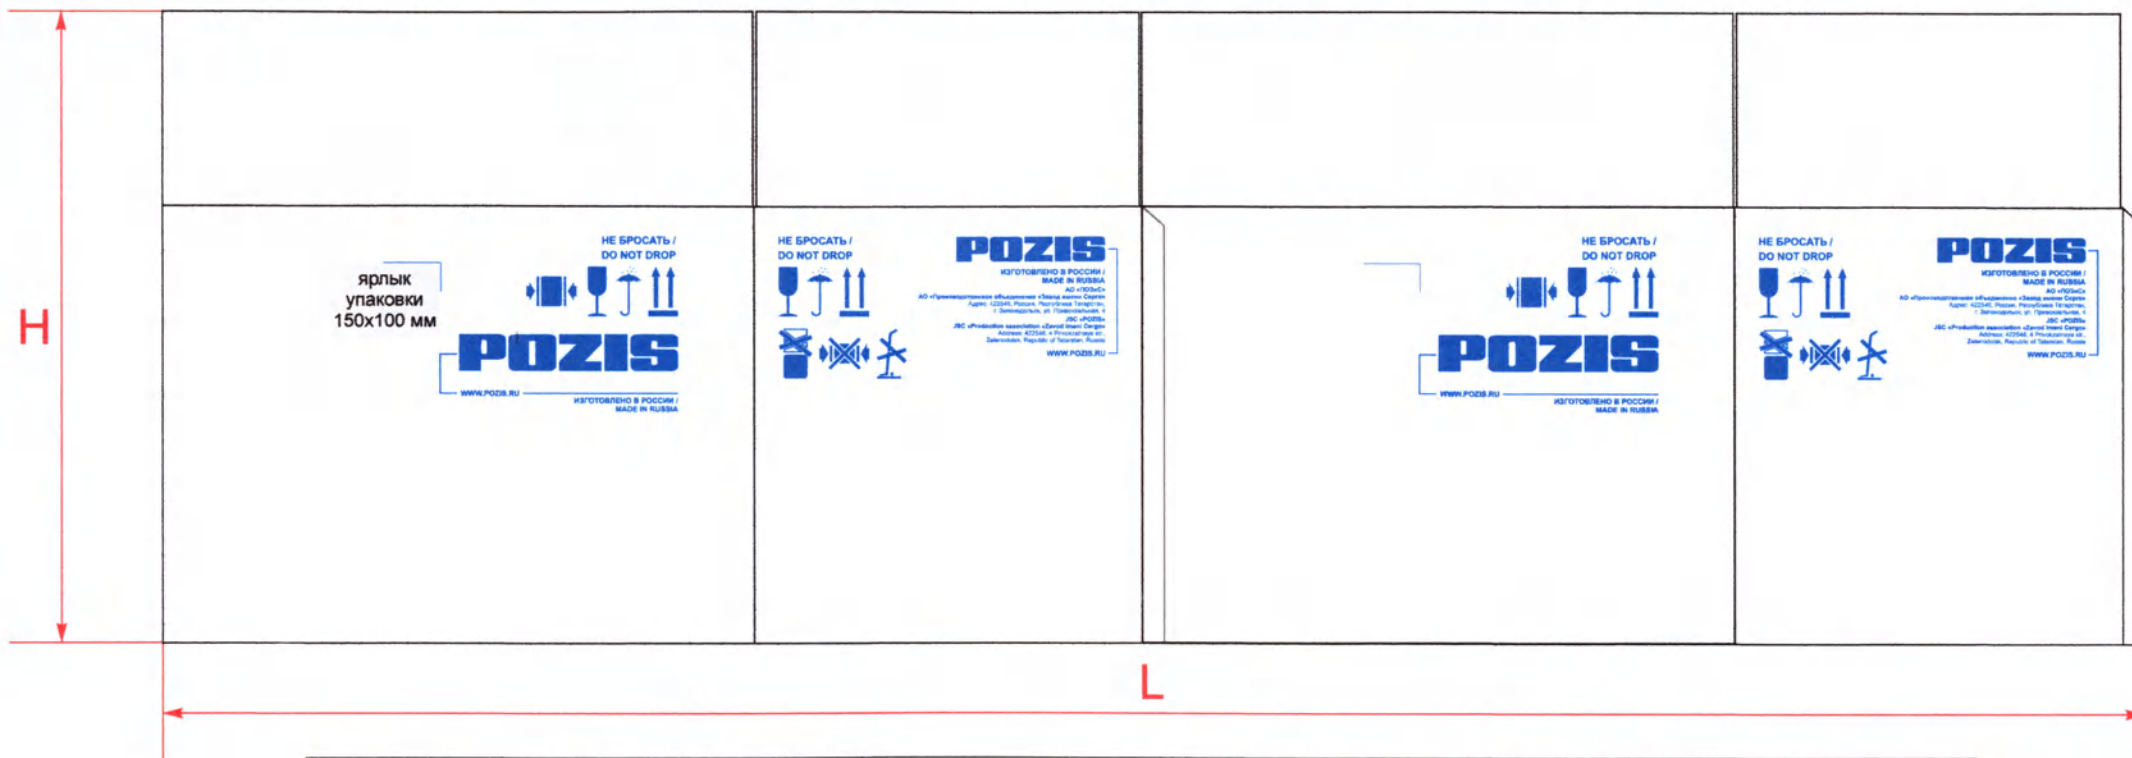

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ	ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ, ММ	
	H	L
МНТ-15 «POZIS»	888	2665
МНТ-80 «POZIS»	1209	3796
МНТ-180 «POZIS»	1209	4738
МНТ-200 «POZIS»	1209	4982
МНТ-300 «POZIS»	1385	6090

МАКЕТ УПАКОВКИ МОРОЗИЛЬНИКОВ-ЛАРЕЙ МЕДИЦИНСКИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МНТ-30 «POZIS»

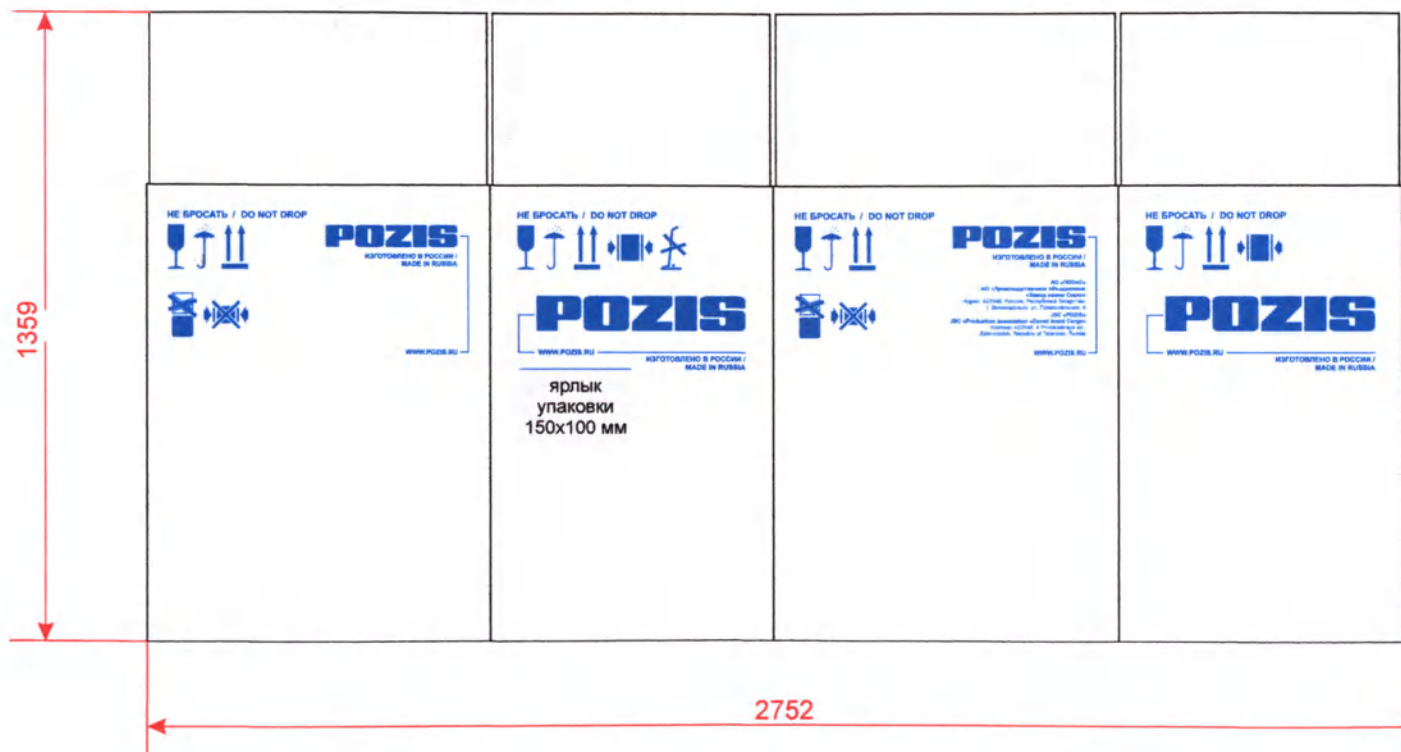

В данном документе прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью (24) жарчат гербов листов(а)
Начальник общего отдела Ю. В. Журина

