

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор центра постгеномных технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)



Г.А. Шипулин

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

набора реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулезного
комплекса методом изотермической петлевой амплификации
«АмплиТест® МБТ-LAMP»


Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 1



Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 1



**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(«LAMP-комплект» вариант FRT-100 F), форма 1**

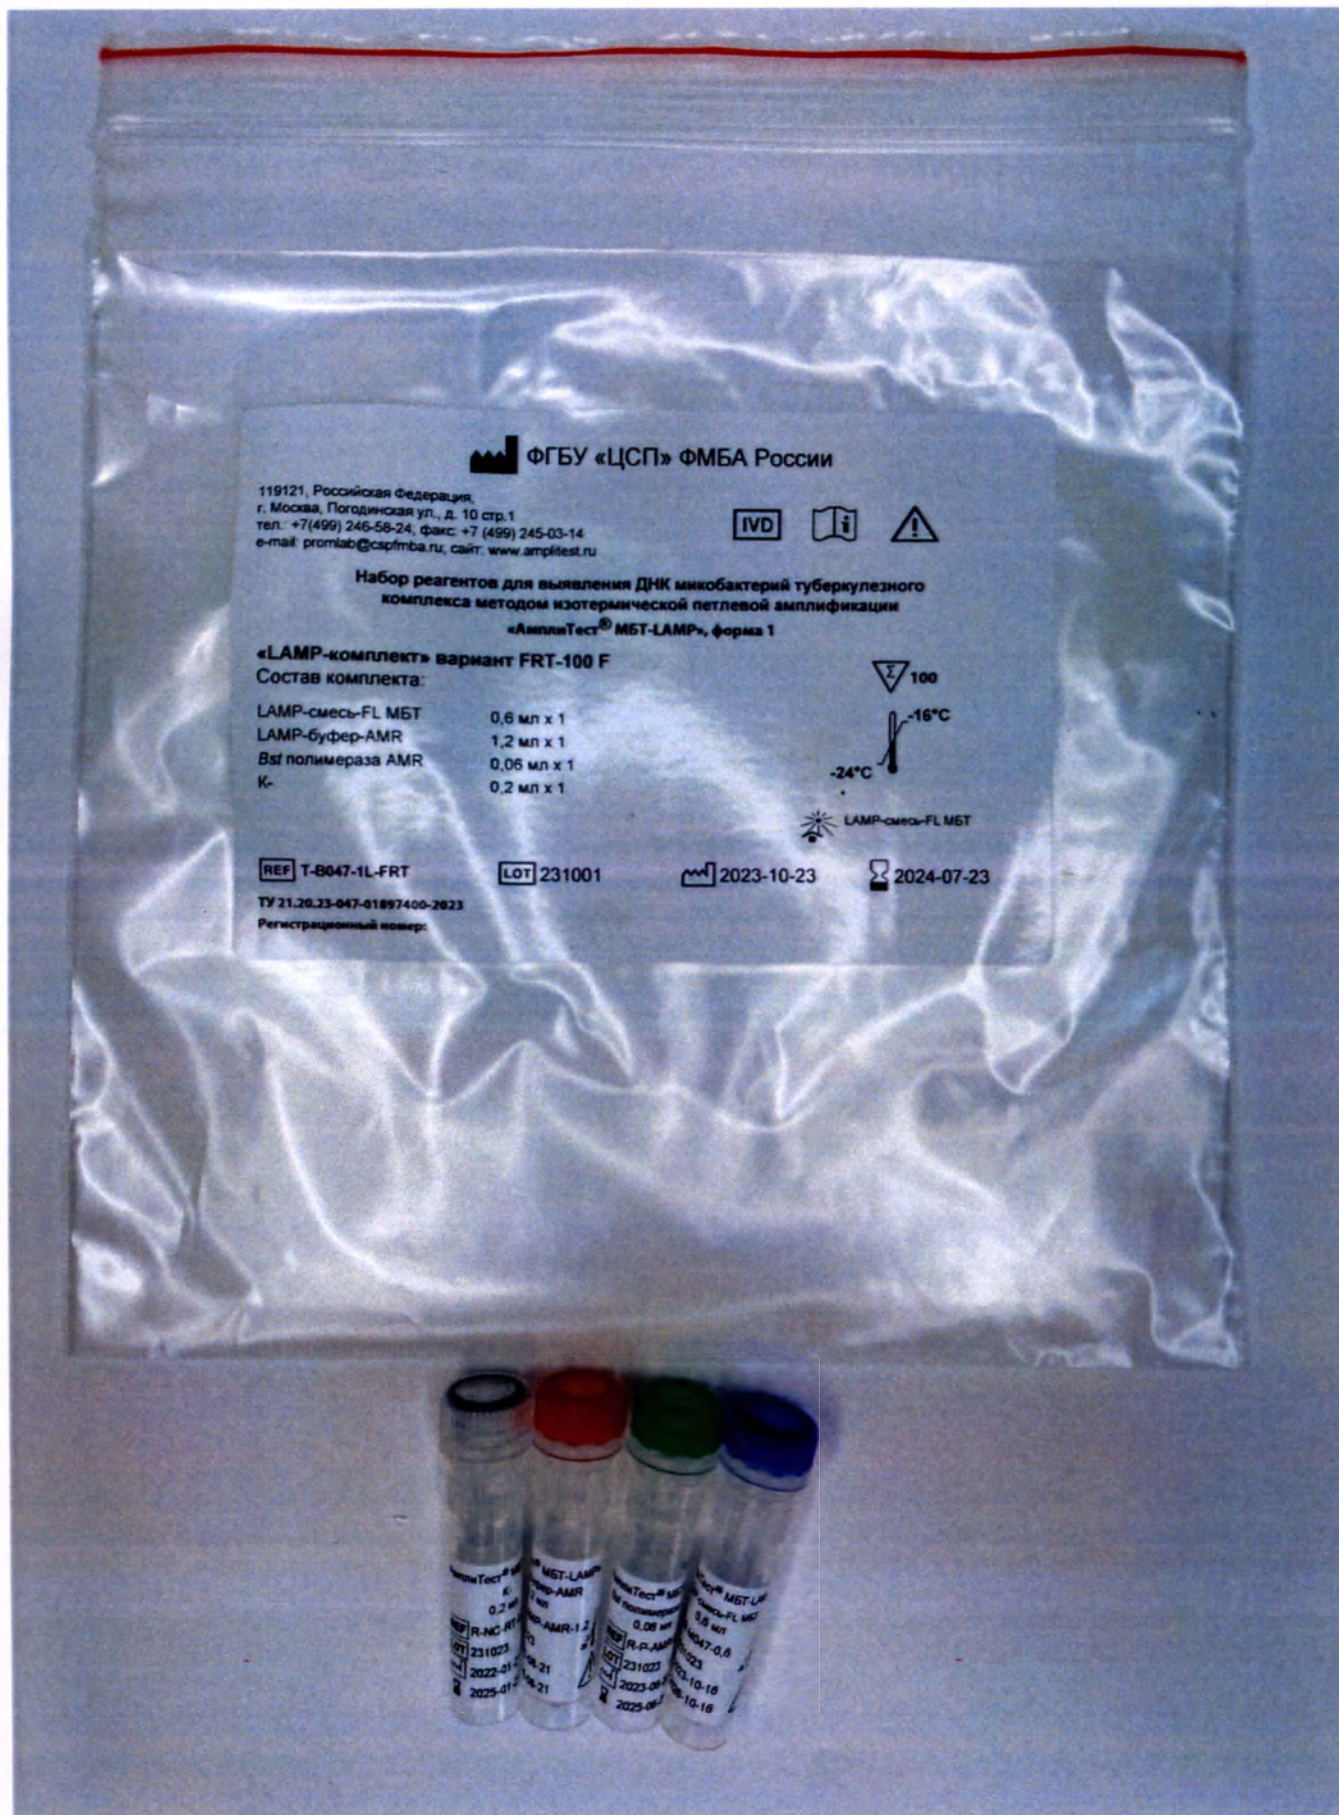


**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(«РИБО-преп ТБ», вариант 100), форма 1**





Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса
методом изотермической петлевой амплификации

«АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 2    

«Магно-Сорб-Комбо ТБ» вариант 100 - комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК
из биологического материала человека и бактериальных культур

«LAMP-комплект» вариант FRT-100 F - комплект реагентов для изотермической
амплификации фрагментов ДНК микобактерий туберкулезного комплекса
(*Mycobacterium tuberculosis complex*) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в
режиме «реального времени»



LAMP-смесь-FL МБТ

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

8°C
2°C
-16°C
-24°C



REF T-B047-2L-FRT LOT 231001

 2023-10-23


 2024-07-23

TU 21.20.23-047-01897400-2023

Регистрационный номер:

119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 2

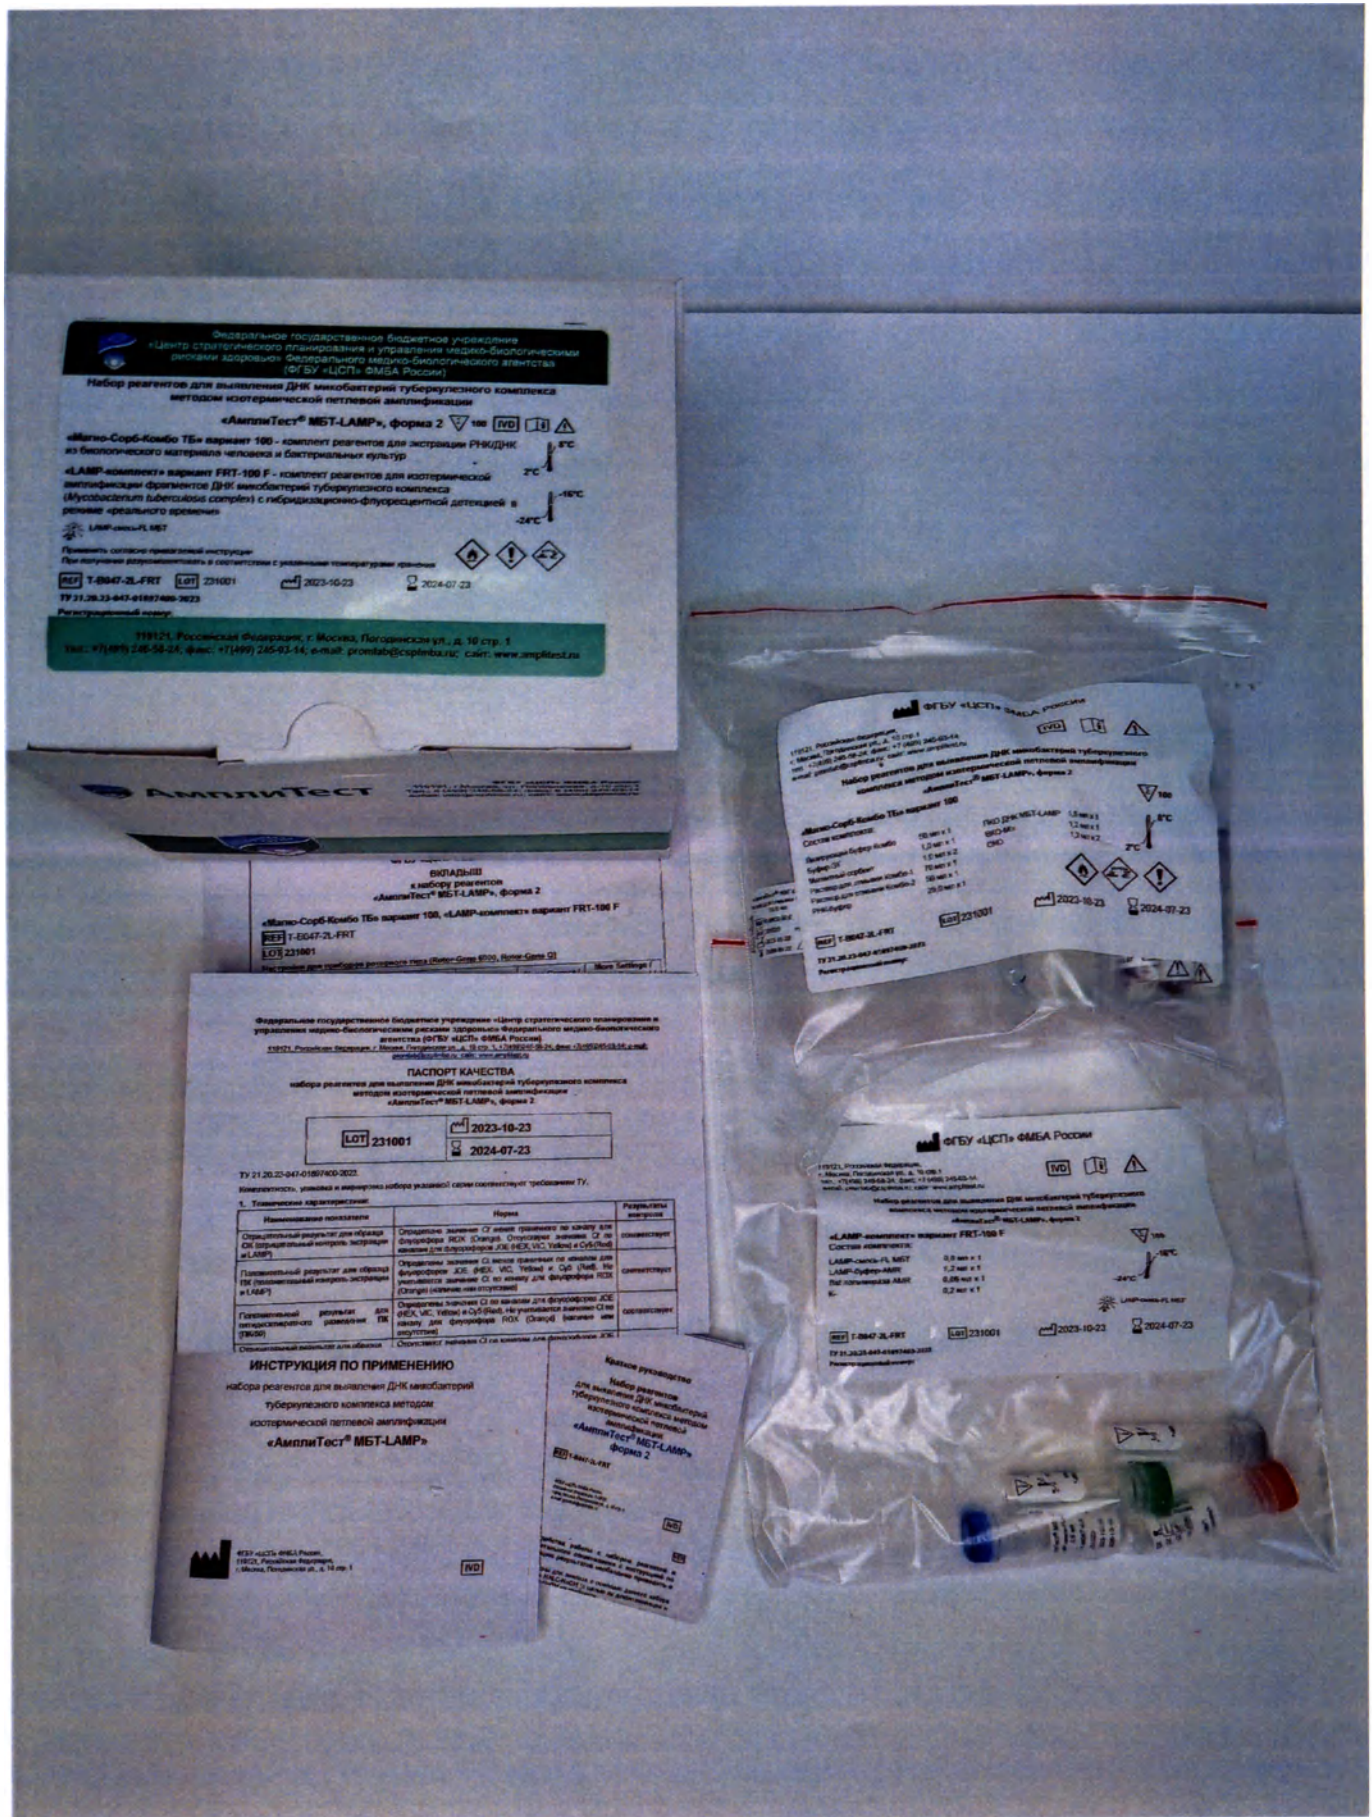


**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(Магно-Сорб-Комбо ТБ, вариант 100), форма 2**



**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(«LAMP-комплект» вариант FRT-100 F), форма 2**



Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 3

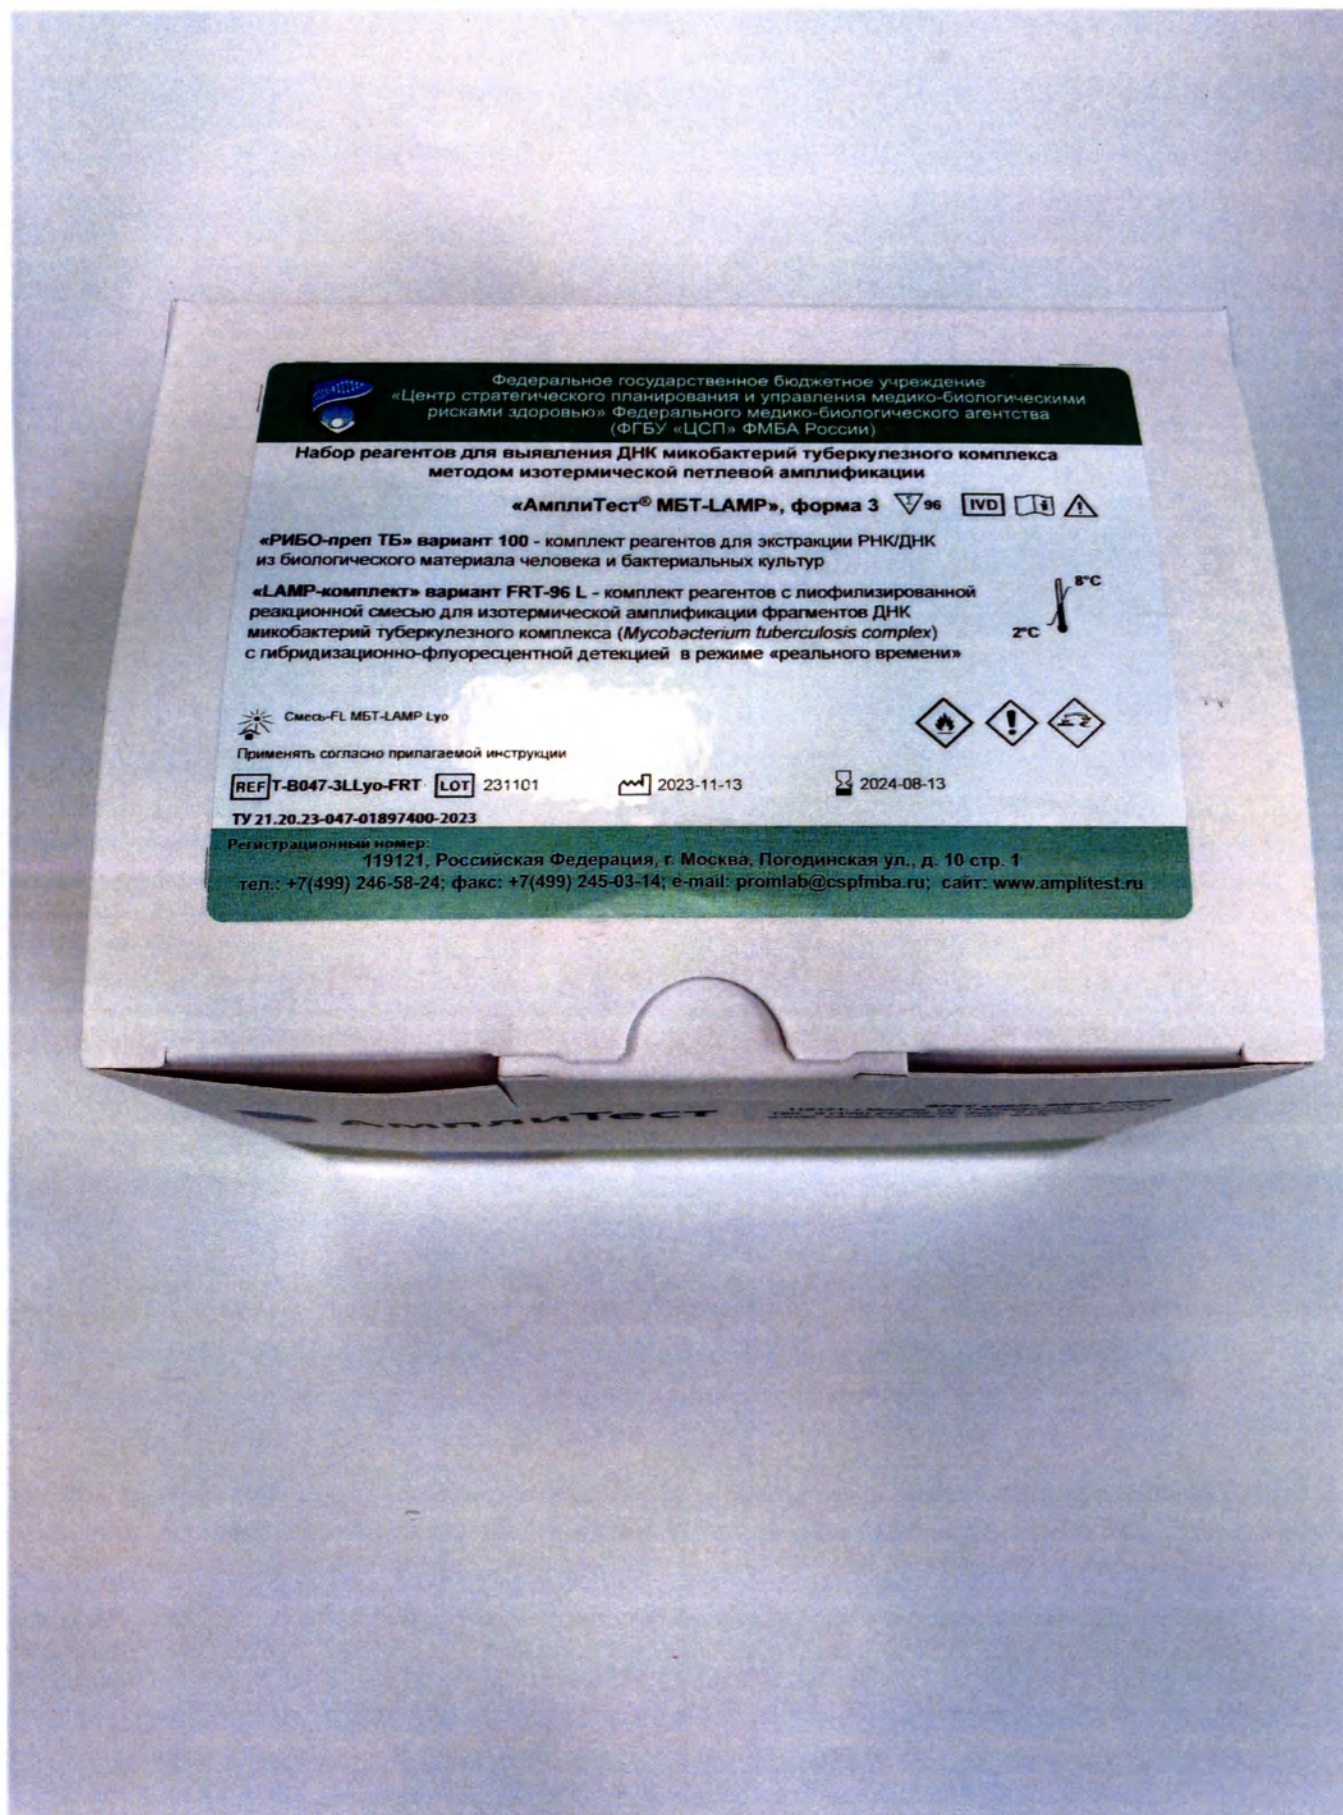


**Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 3**



**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(РИБО-преп ТБ, вариант 100), форма 3**



**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(«LAMP-комплект») вариант FRT-96 L), форма 3**

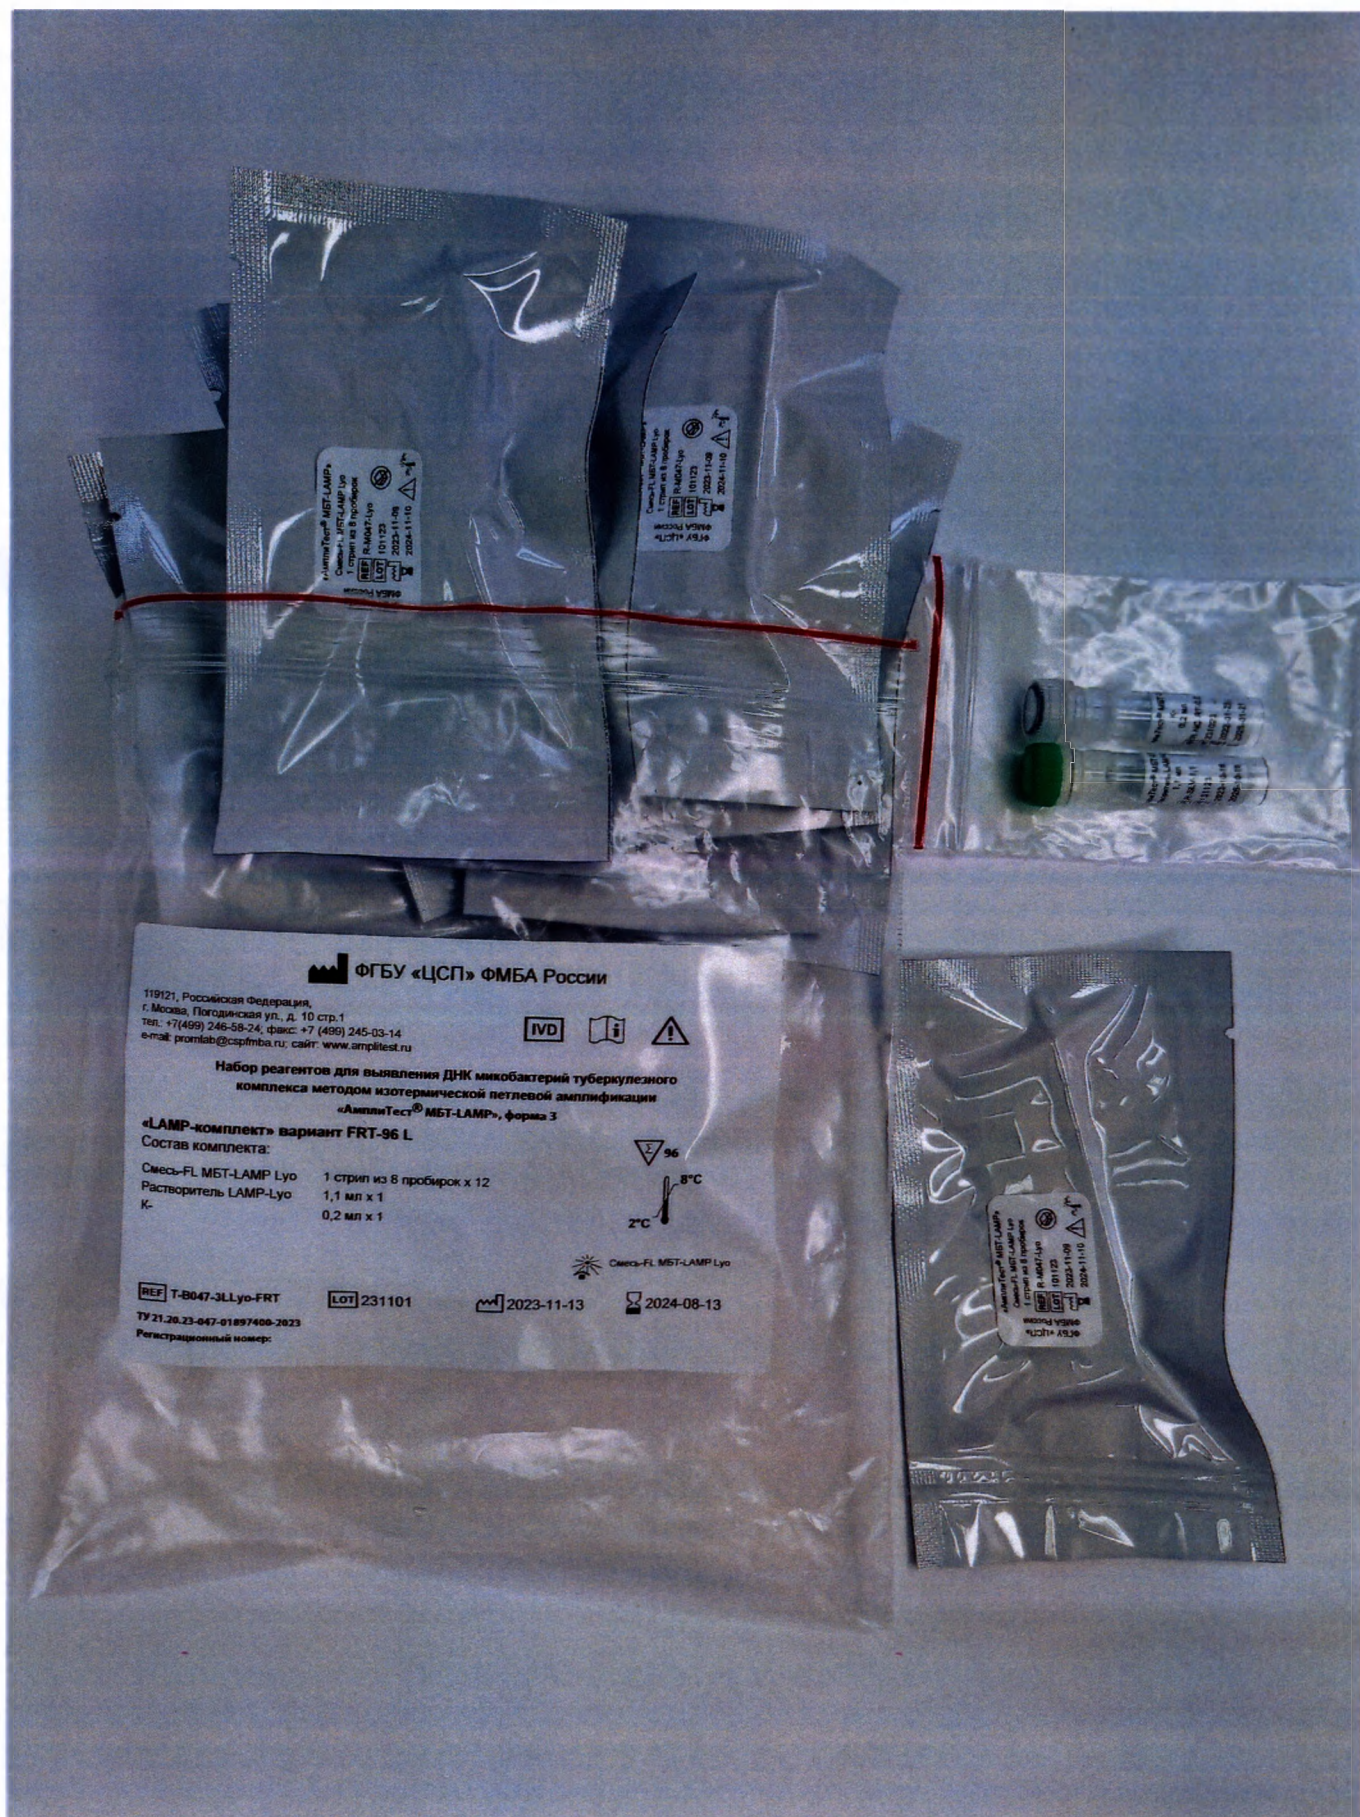



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

**Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса
методом изотермической петлевой амплификации**

«АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 4   

«Магно-Сорб-Комбо ТБ» вариант 100 - комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК
из биологического материала человека и бактериальных культур

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 L - комплект реагентов с лиофилизированной
реакционной смесью для изотермической амплификации фрагментов ДНК
микобактерий туберкулезного комплекса (*Mycobacterium tuberculosis complex*)
с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»



 Смесь-FL МБТ-LAMP Lyo

Применять согласно прилагаемой инструкции

REF T-B047-4LLyo-FRT **LOT** 231101  2023-11-13  2024-08-13

TU 21.20.23-047-01897400-2023


Регистрационный номер:

119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru


Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® МБТ-LAMP», форма 4



Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(Магно-Сорб-Комбо ТБ, вариант 100), форма 4

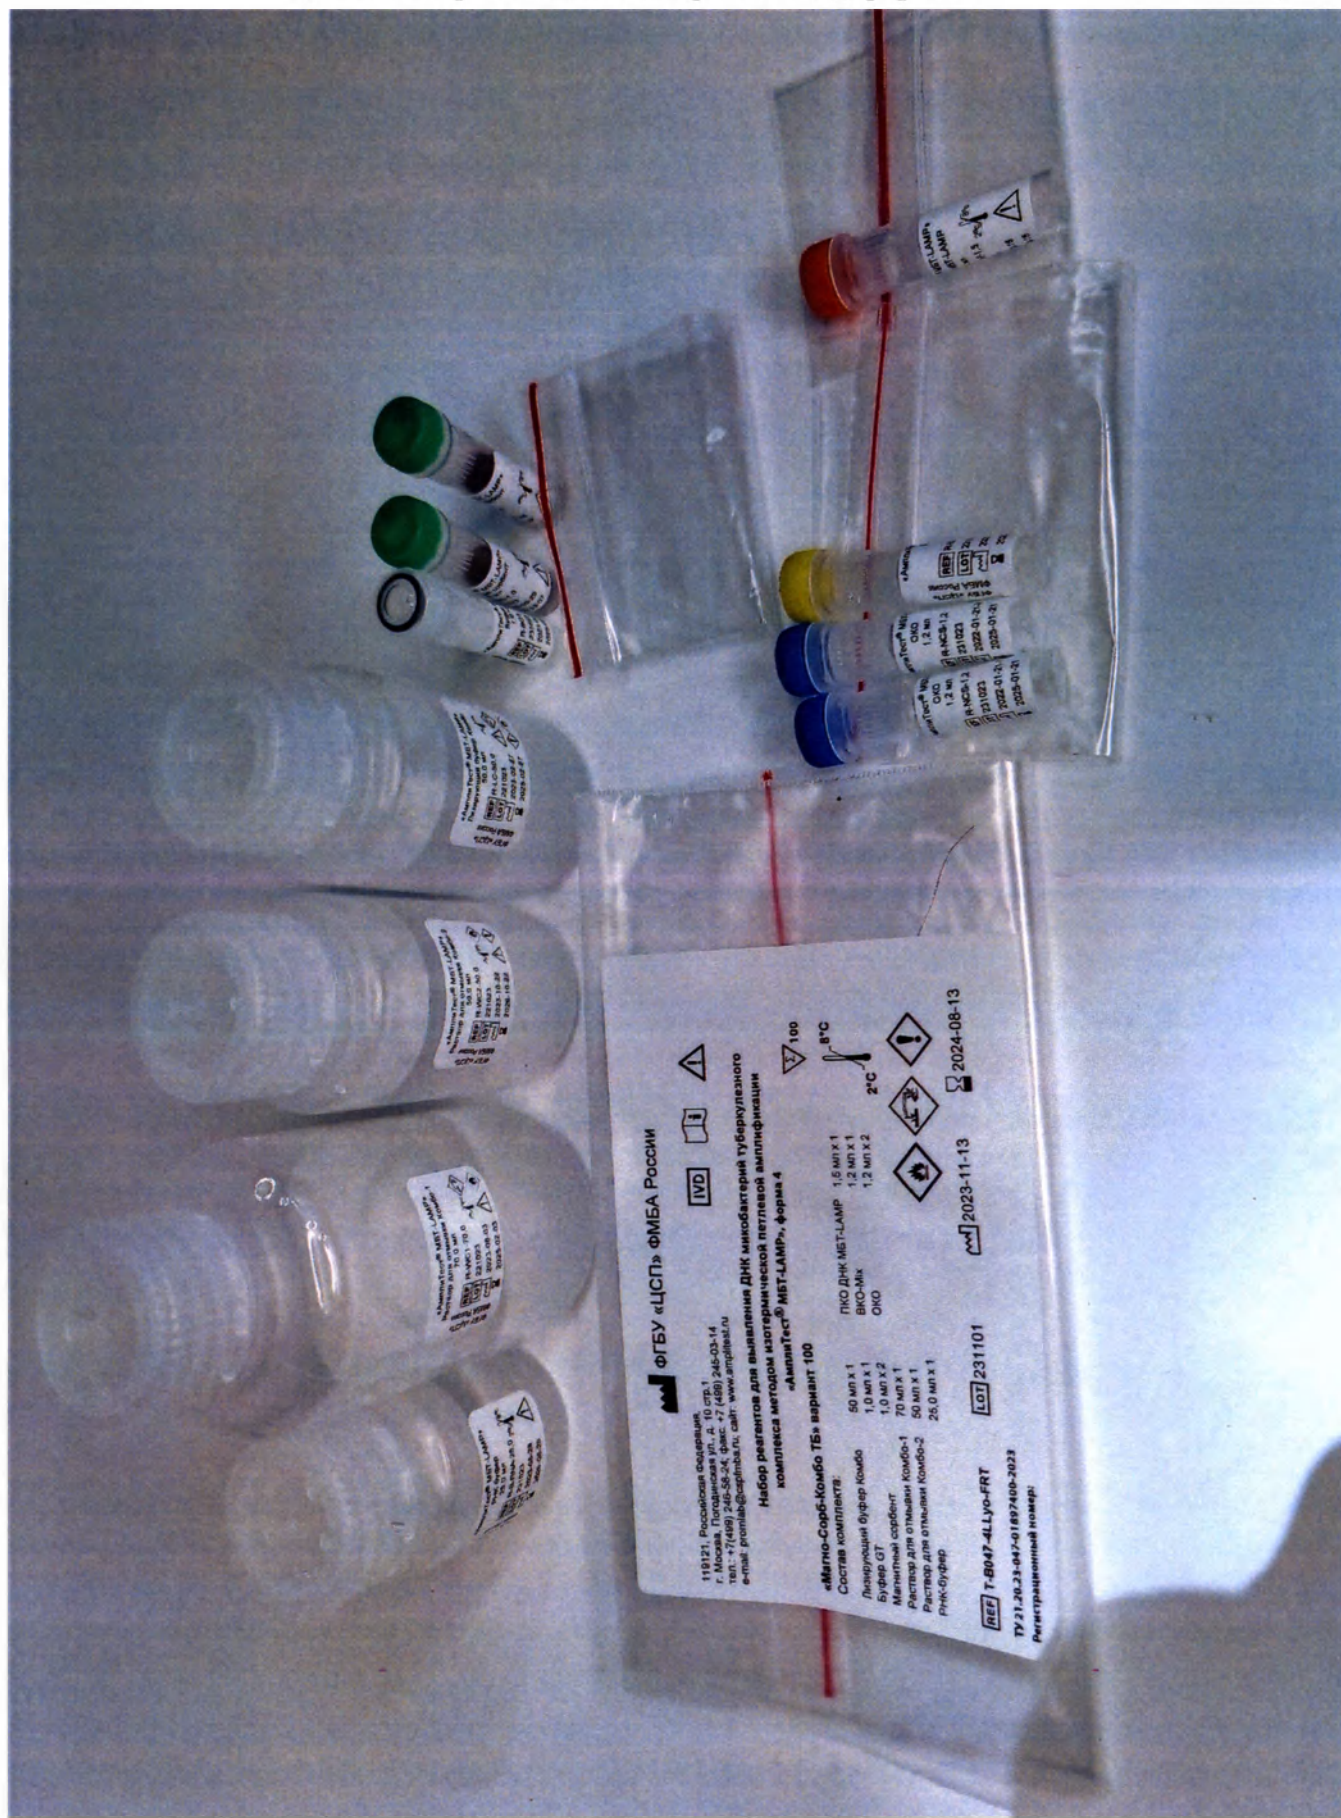

**Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ-LAMP»
(«LAMP-комплект» вариант FRT-96 L), форма 4**

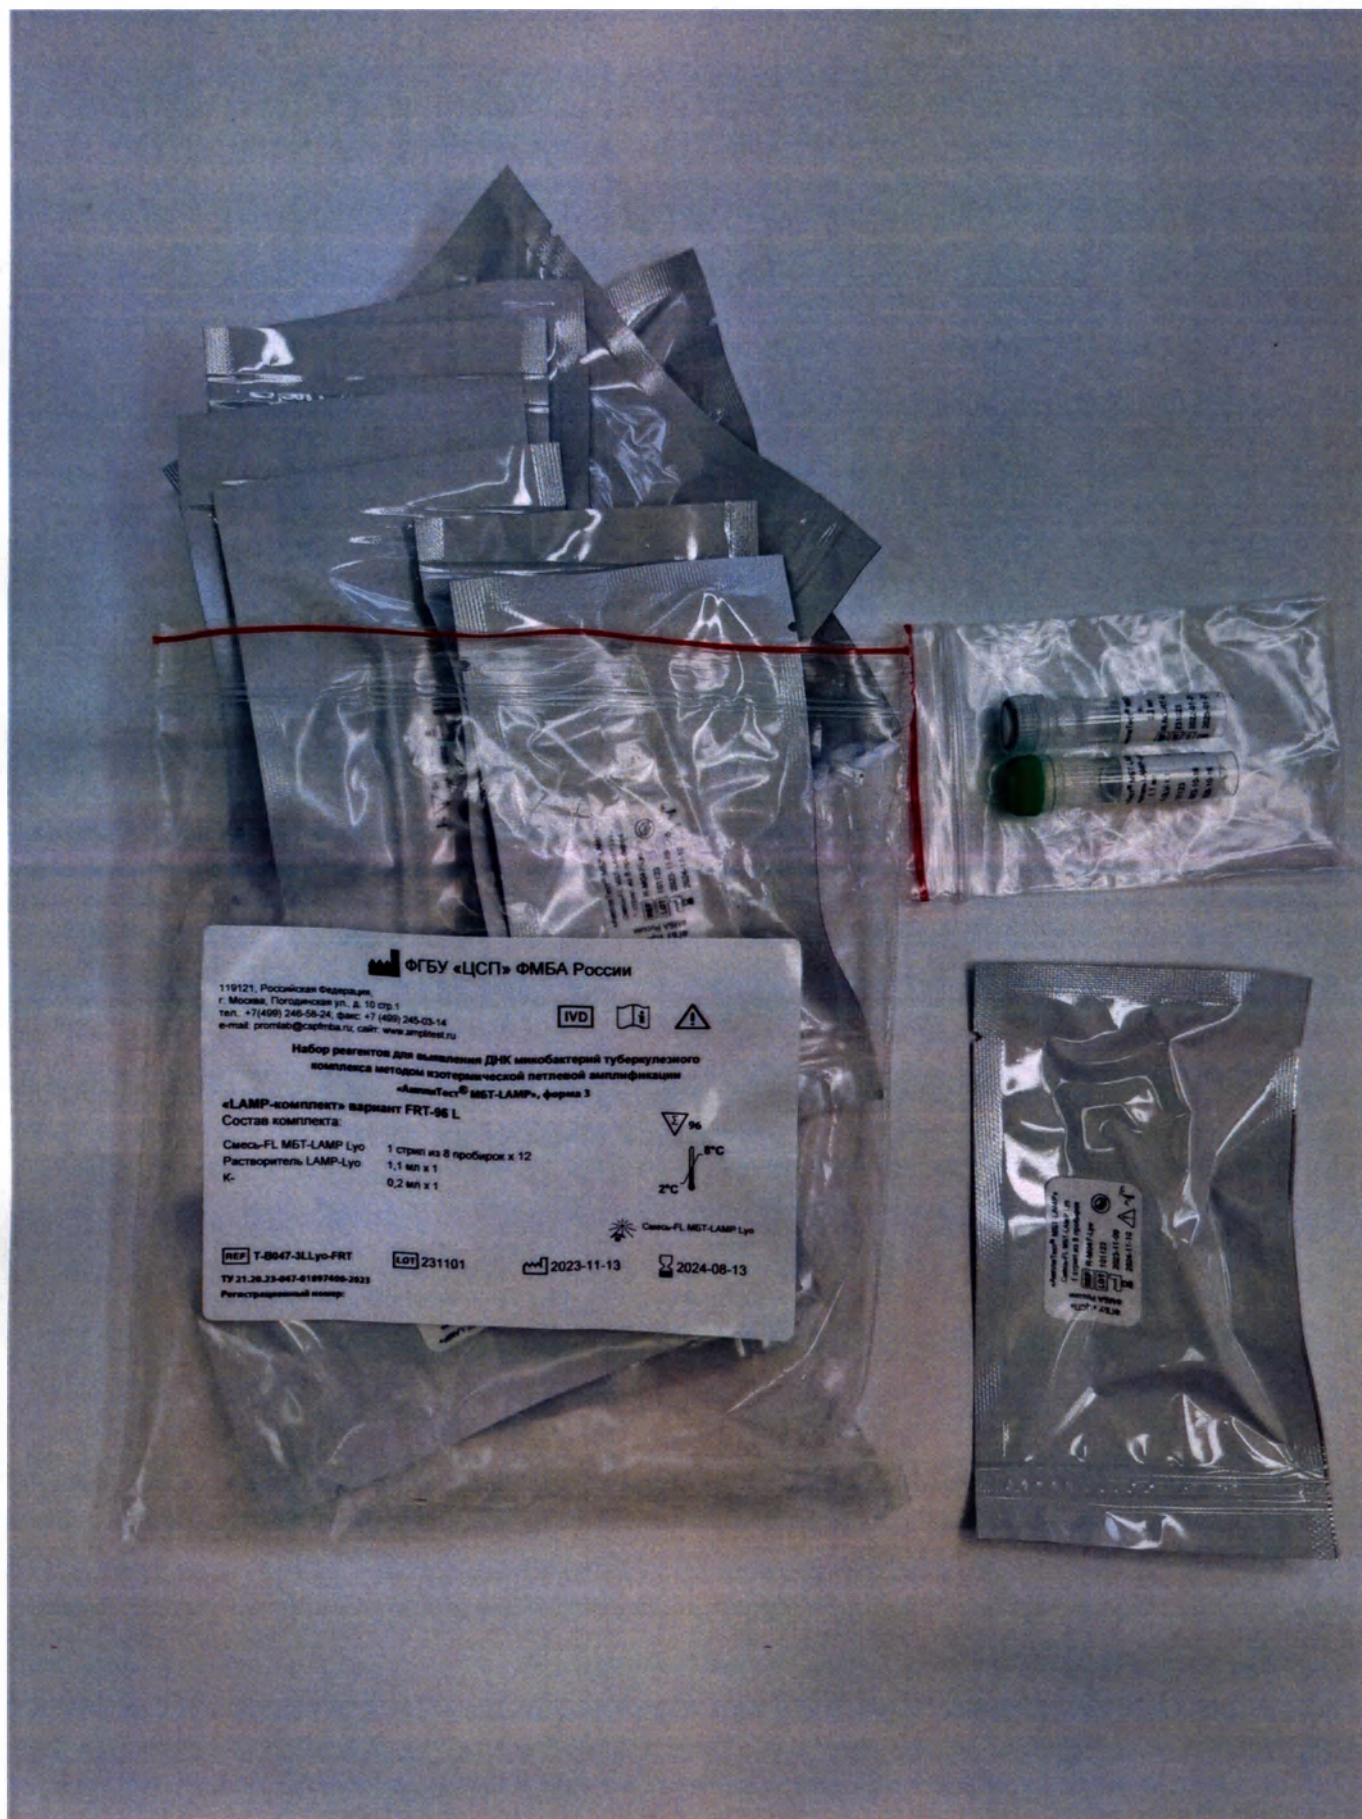

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 14 лист об
Директор центра постгеномных технологий ФГБУ
«ЦСП» ФМБА России



 Г.А. Шипулин