



Фотографические изображения
медицинского изделия


***Система ультразвуковая диагностическая меди-
цинская Logiq S8 с принадлежностями.***

УТВЕРЖДАЮ


Менеджер по контролю
качества и мониторингу
безопасности медицинского
оборудования Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлсеа»

И.А. Суханова



« 29 » _____ 2019г.

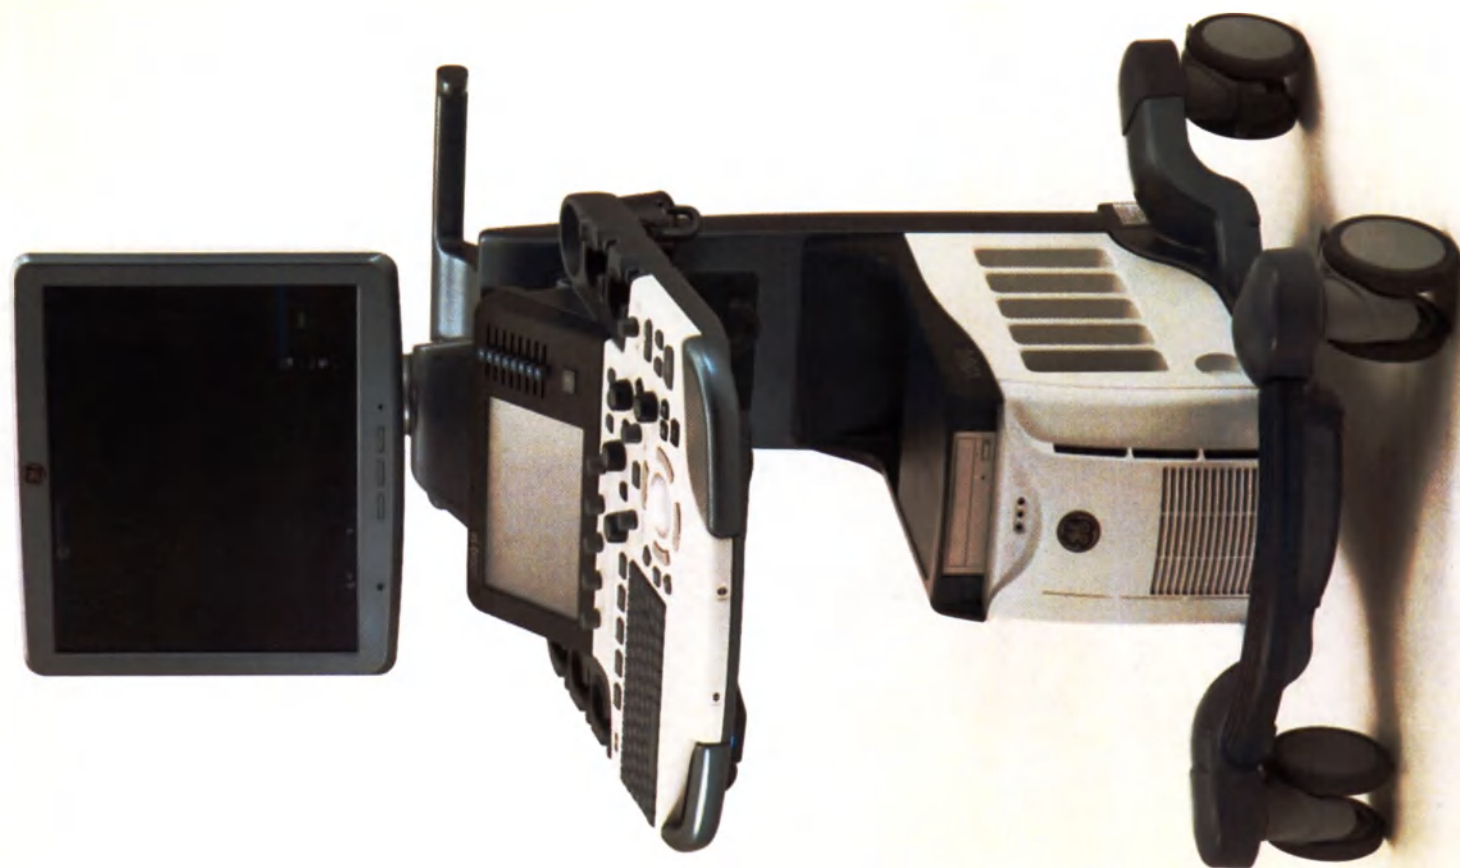



GE Ultrasound Korea,Ltd.
9, Sunhwan-ro 214beon-gil,
Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea

121 kg

100-120V~, 50/60Hz, 900VA

220-240V~, 50/60Hz, 900VA

LOGIQ S8 версия R2



1234567



2019-11



123456789



BAR CODE

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8 с принадлежностями (версия R3)





GE Ultrasound Korea,Ltd.
9, Sunhwan-ro 214beon-gil,
Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea

121 kg

Класс 1

100-120V~, 50/60Hz, 900VA

220-240V~, 50/60Hz, 900VA

LOGIQ S8 версия R3



1234567



2019-11



123456789

АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	
для "GE Ultrasound Korea, Ltd."	
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8	
Модель	Logiq S8
Версия	R3
Зав. номер	
Дата выпуска	XX.XX.XXXX
~ 100-120В, 50/60Гц, 900ВА ~ 220-240В, 50/60Гц, 900ВА	
ЕАС 	
Сделано в России	
XXXXXXX_Y	

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8 с принадлежностями (версия R4)





GE Ultrasound Korea,Ltd.
9, Sunhwan-ro 214beon-gil,
Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea

121 kg

Class I

100-120V~, 50/60Hz, 900VA

220-240V~, 50/60Hz, 900VA

LOGIQ S8

1234567



LOGIQ S8 R4



2016-01




123456789



(01)0000000000000000
(11)000000(21)0000000000

АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	
для "GE Ultrasound Korea, Ltd."	
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8	
Модель	Logiq S8
Версия	R4
Зав. номер	
Дата выпуска	XX.XX.XXXX
~ 100-120В, 50/60Гц, 900ВА ~ 220-240В, 50/60Гц, 900ВА	
EAC PC	
Сделано в России	
XXXXXXX_Y	

Системный блок для системы ультразвуковой диагностической медицинской. (версия R2)

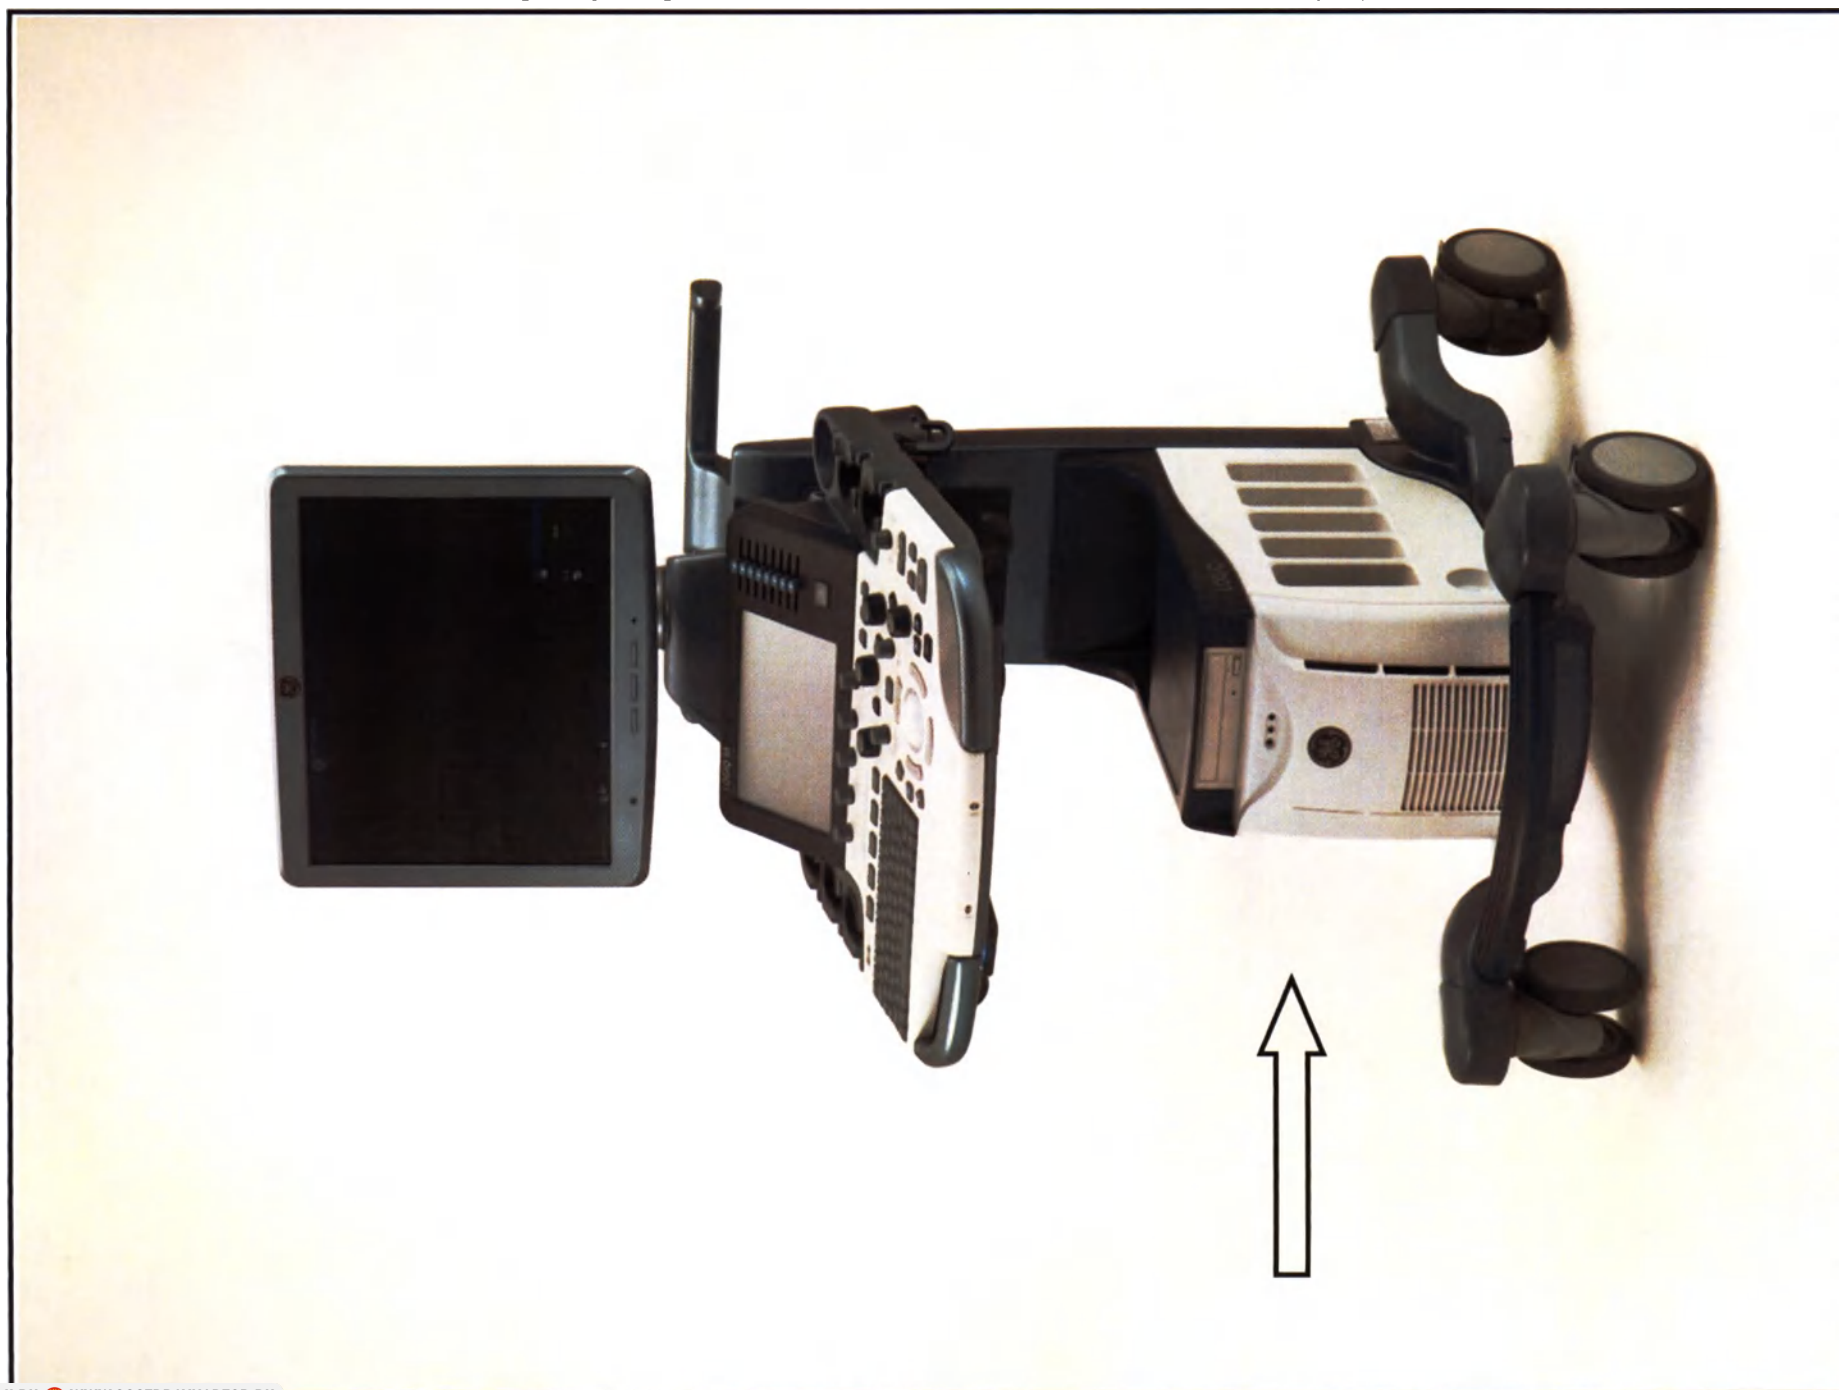

Системный блок для системы ультразвуковой диагностической медицинской. (версия R3)



Системный блок для системы ультразвуковой диагностической медицинской. (версия R4)




Монитор специальный медицинский. (версия R2)




Монитор специальный медицинский. (версия R3, R4)



Монитор специальный медицинский. (версия R3, R4)

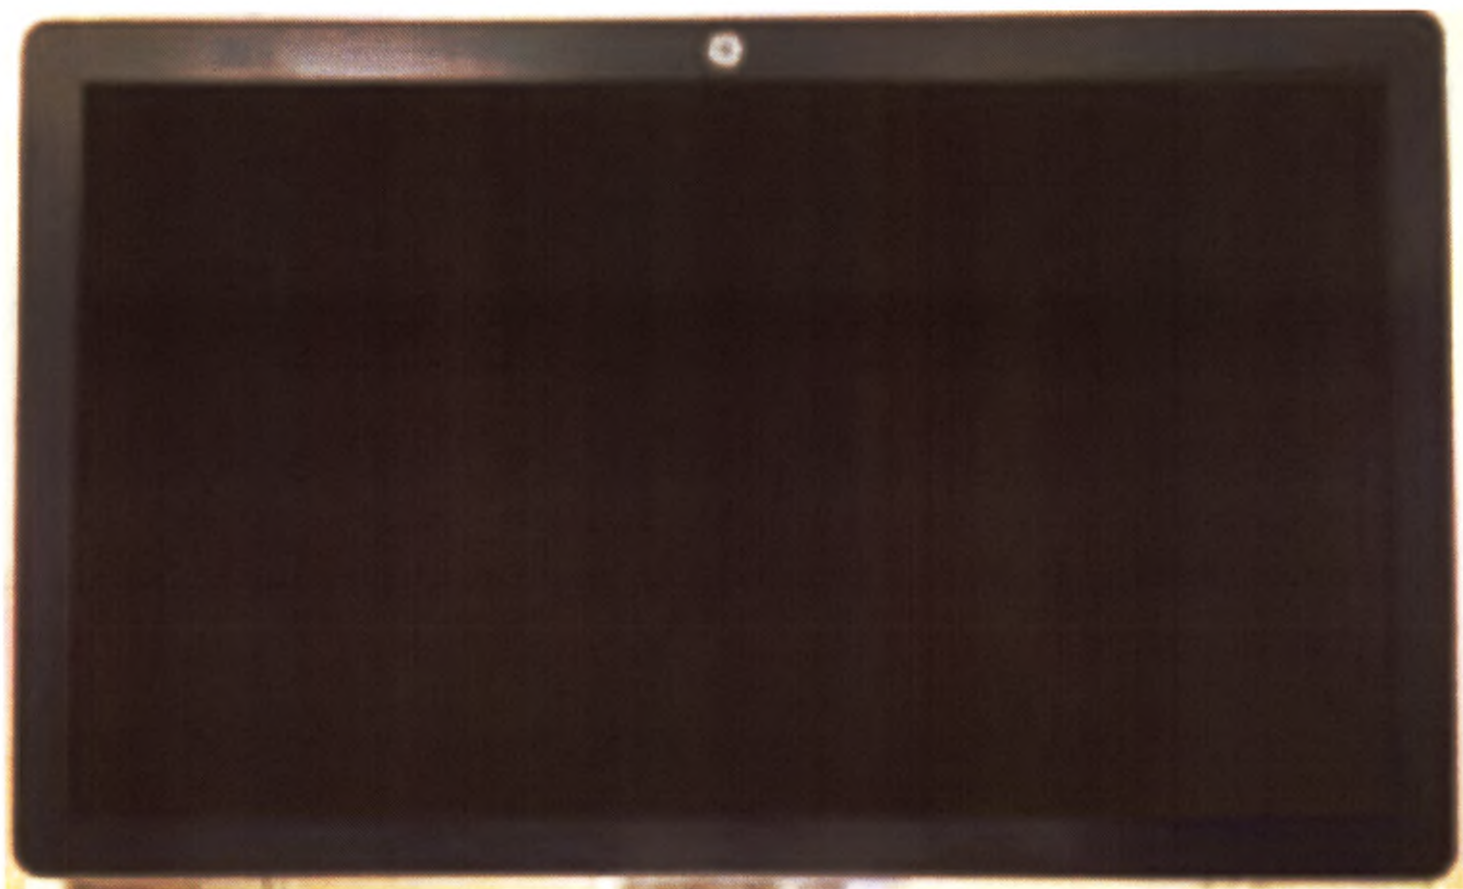

Монитор специальный медицинский. (версия R3, R4)

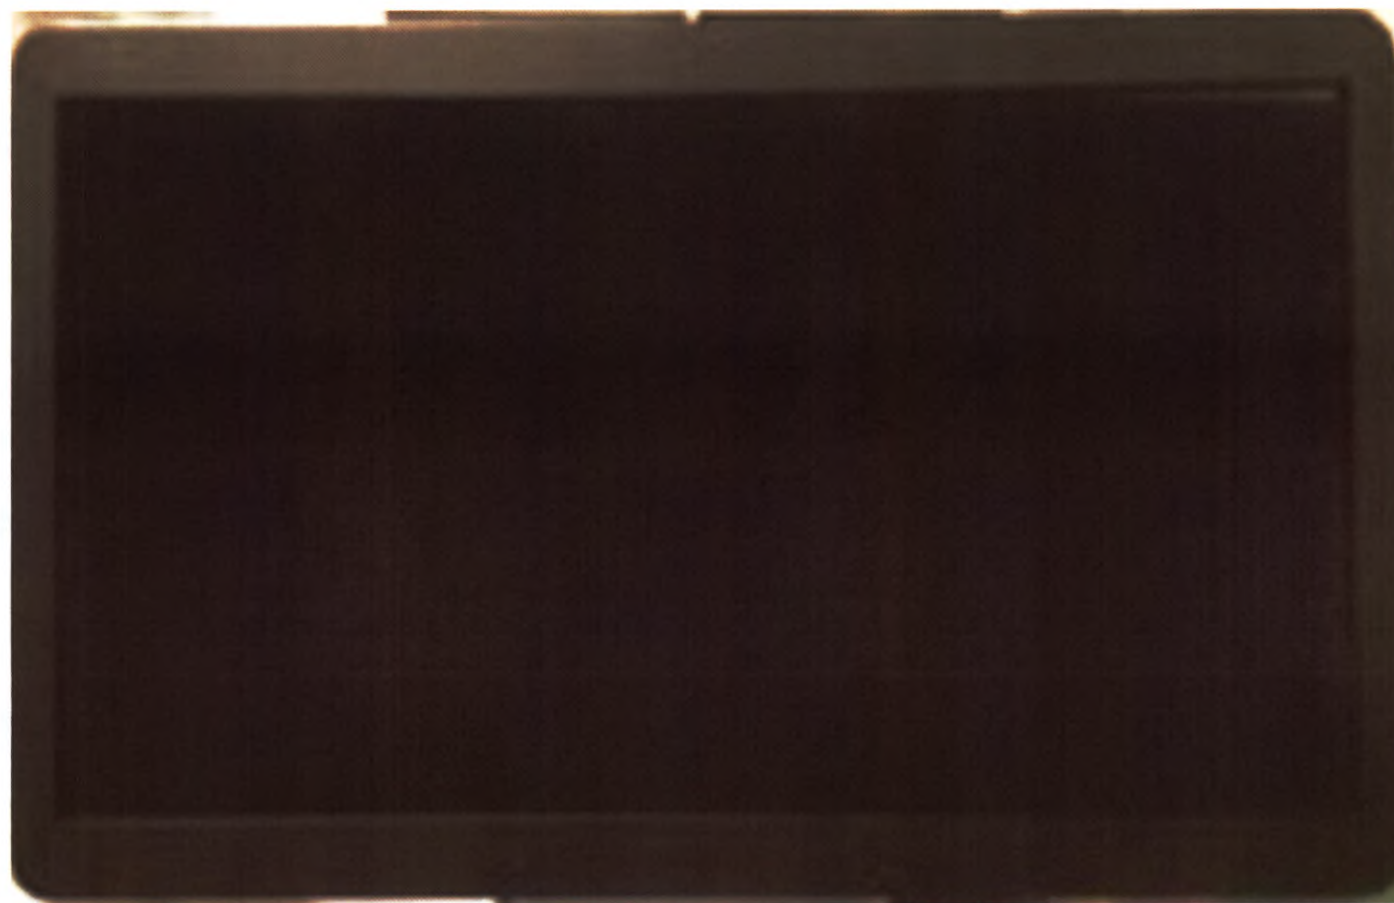


Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской. (версия R2,R3,R4)



Руководство пользователя (не более 10 шт.). (версия R2,R3,R4)




II. Принадлежности: Датчики секторные фазированные серии S (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

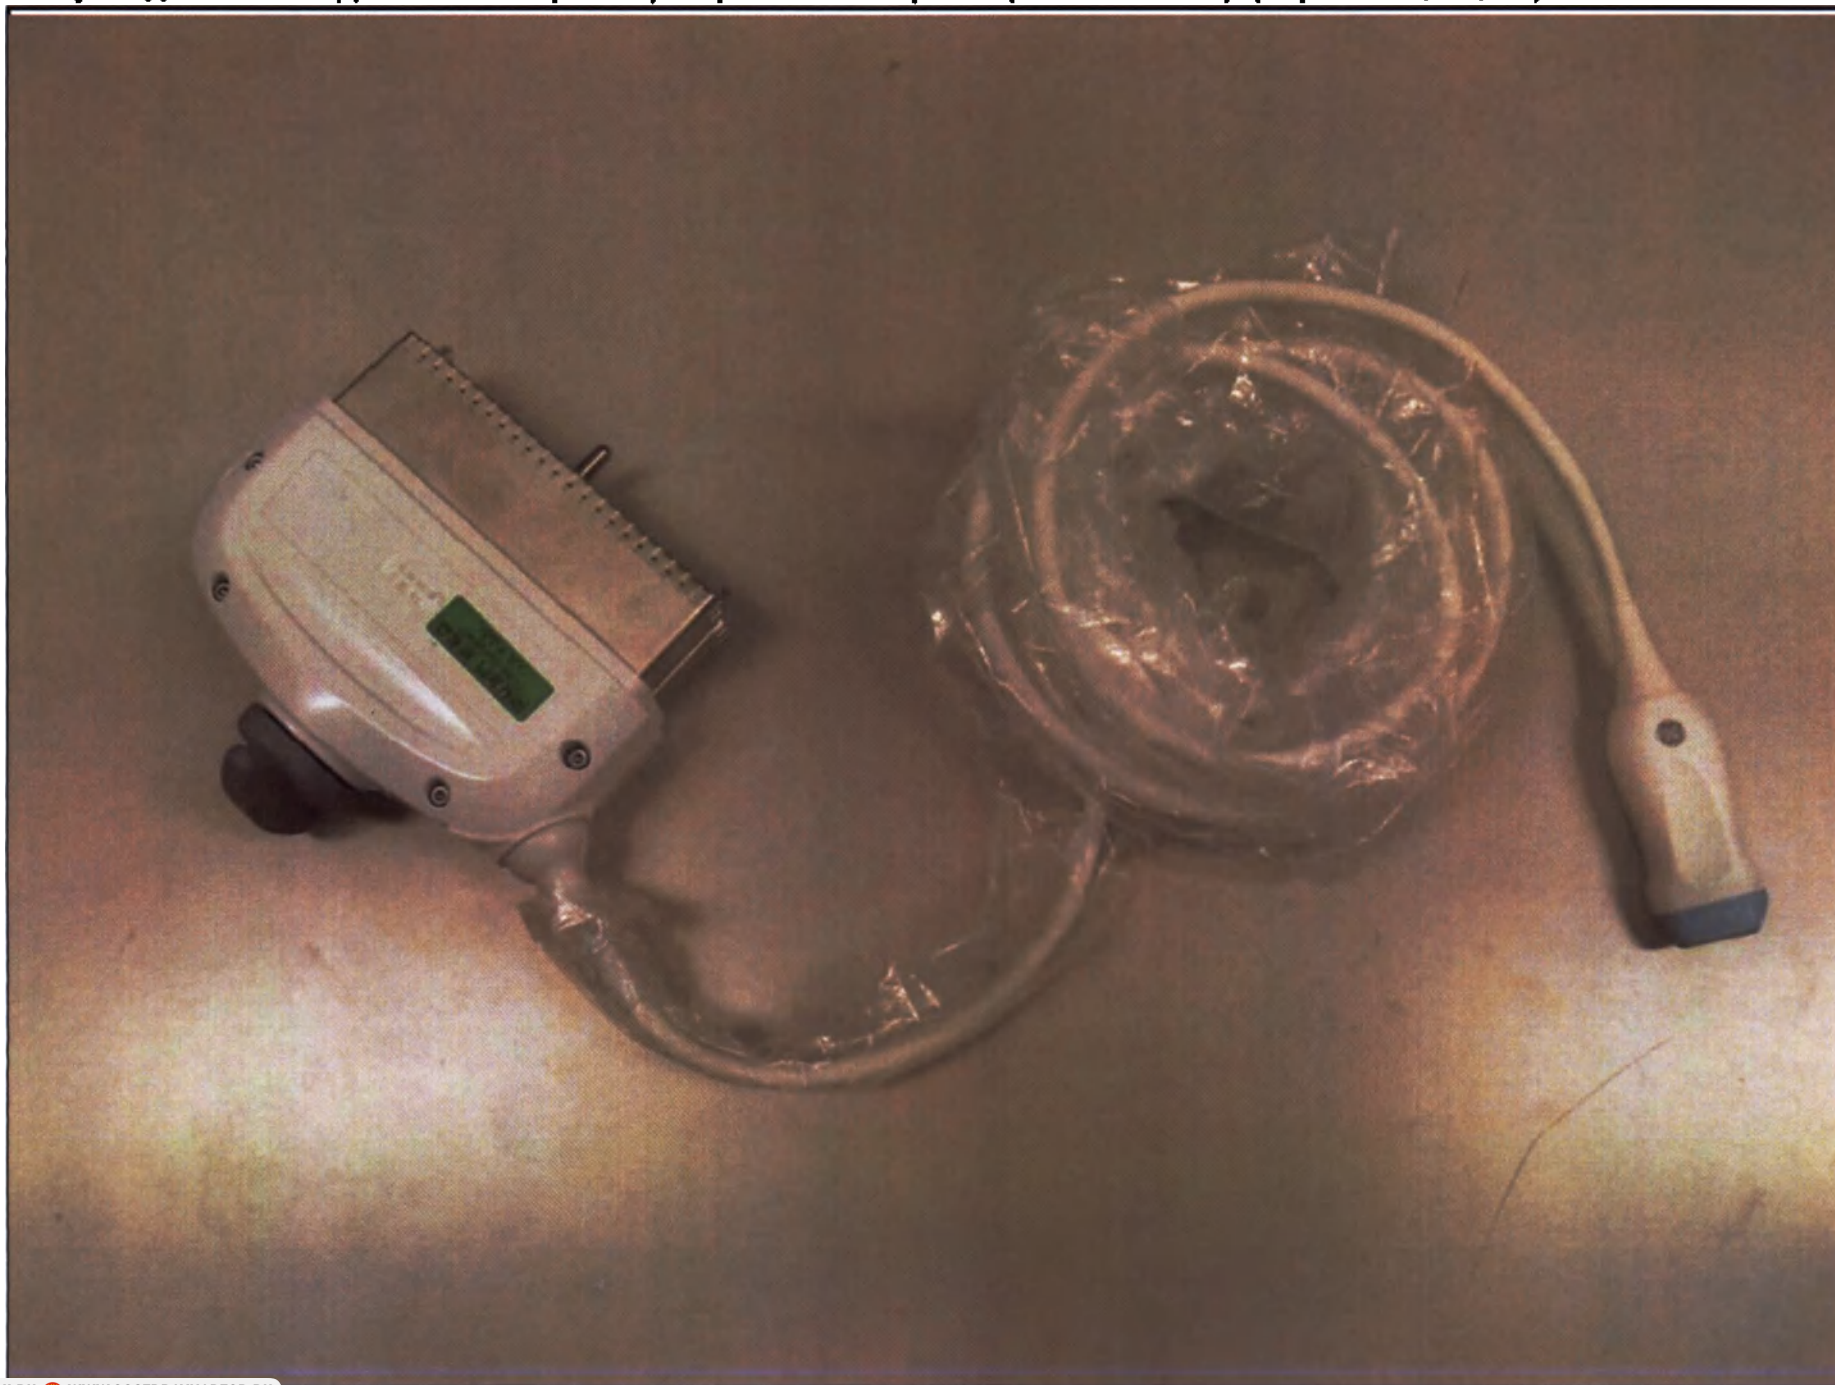


Датчики секторные фазированные серии S (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики секторные фазированные серии S (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

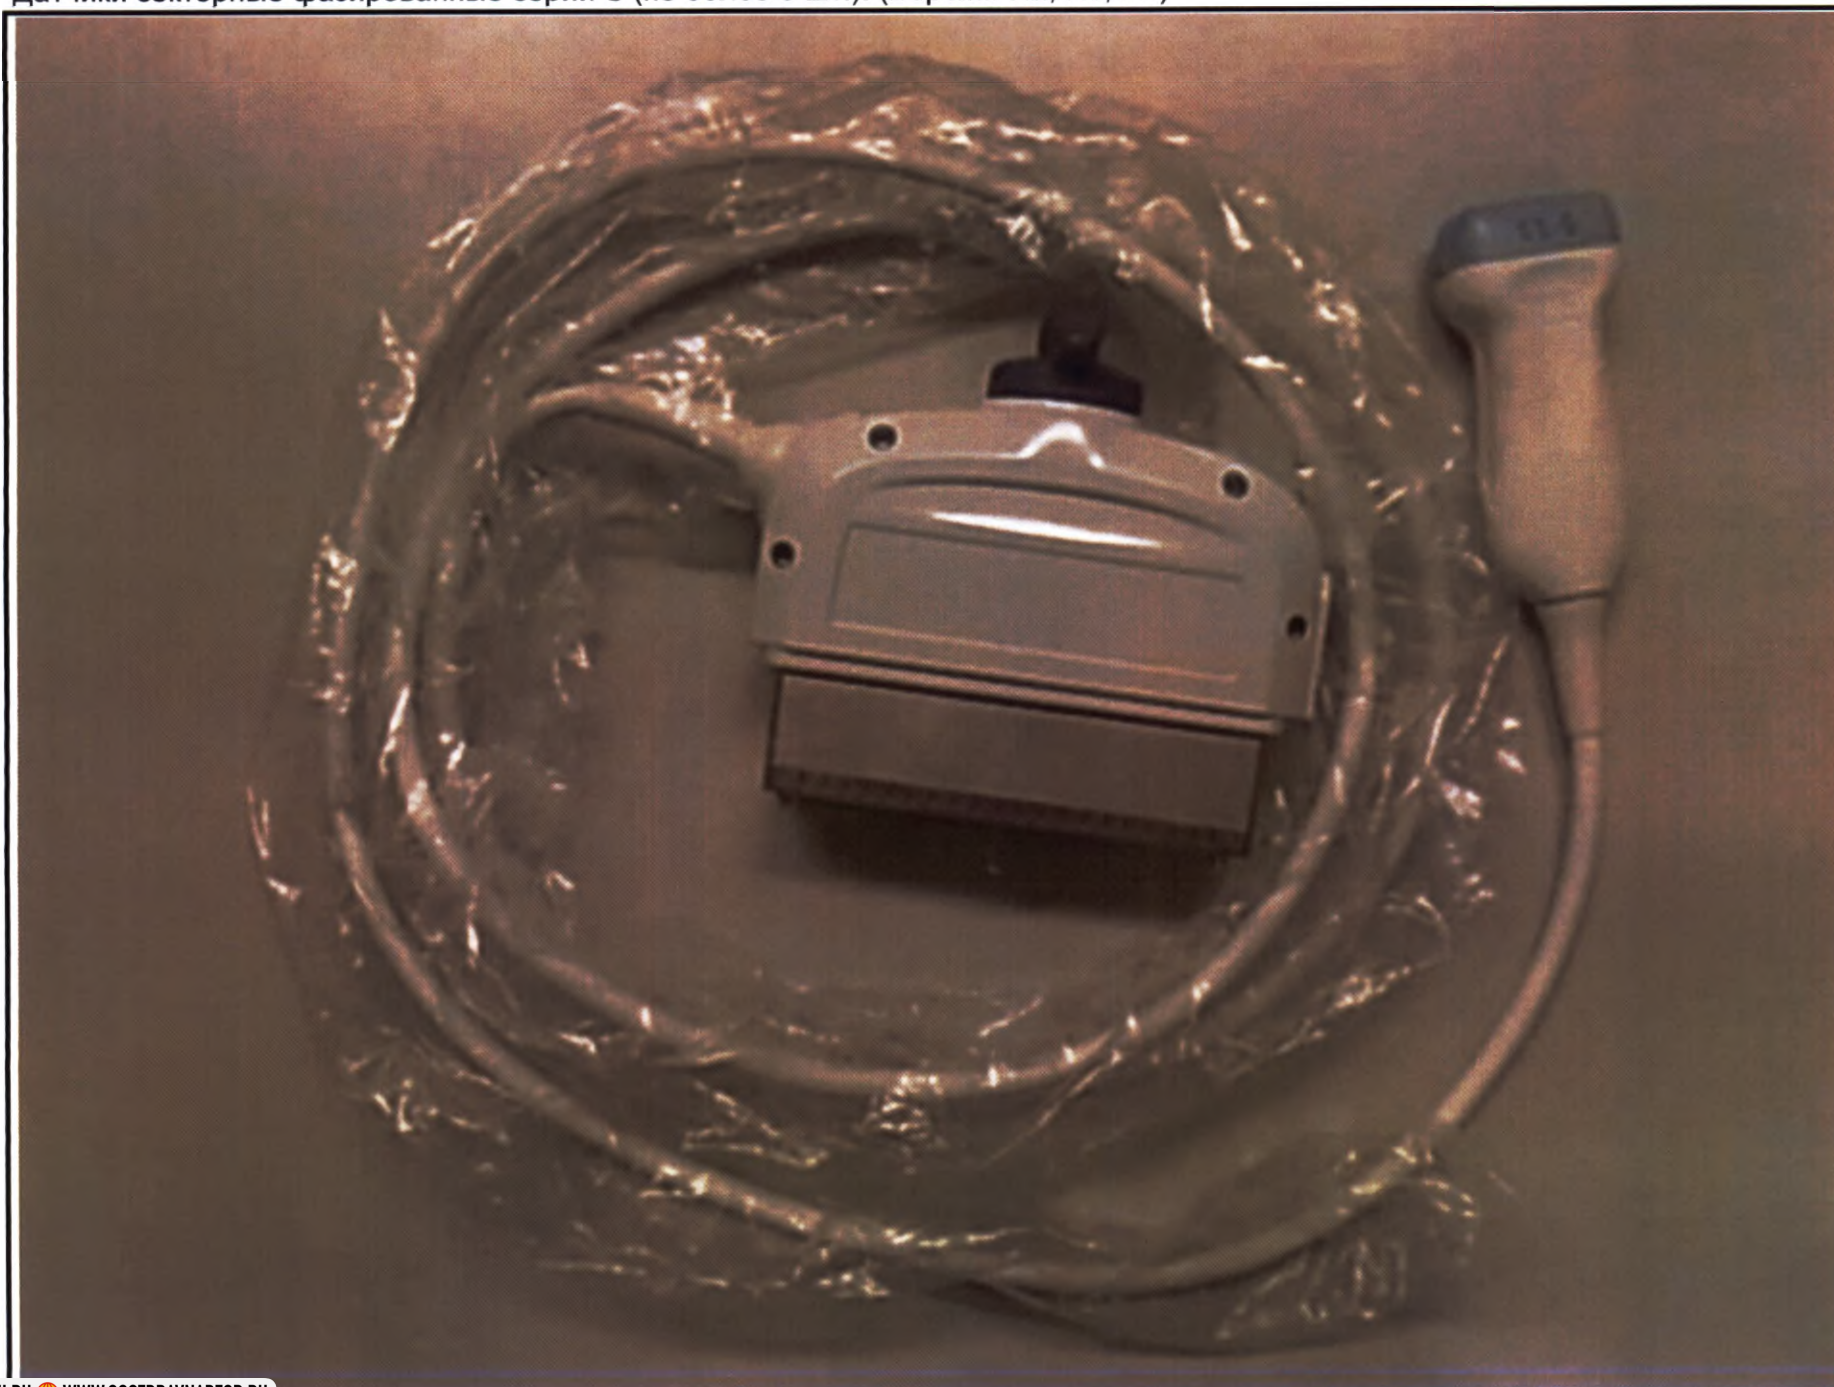

Датчики секторные фазированные серии S (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

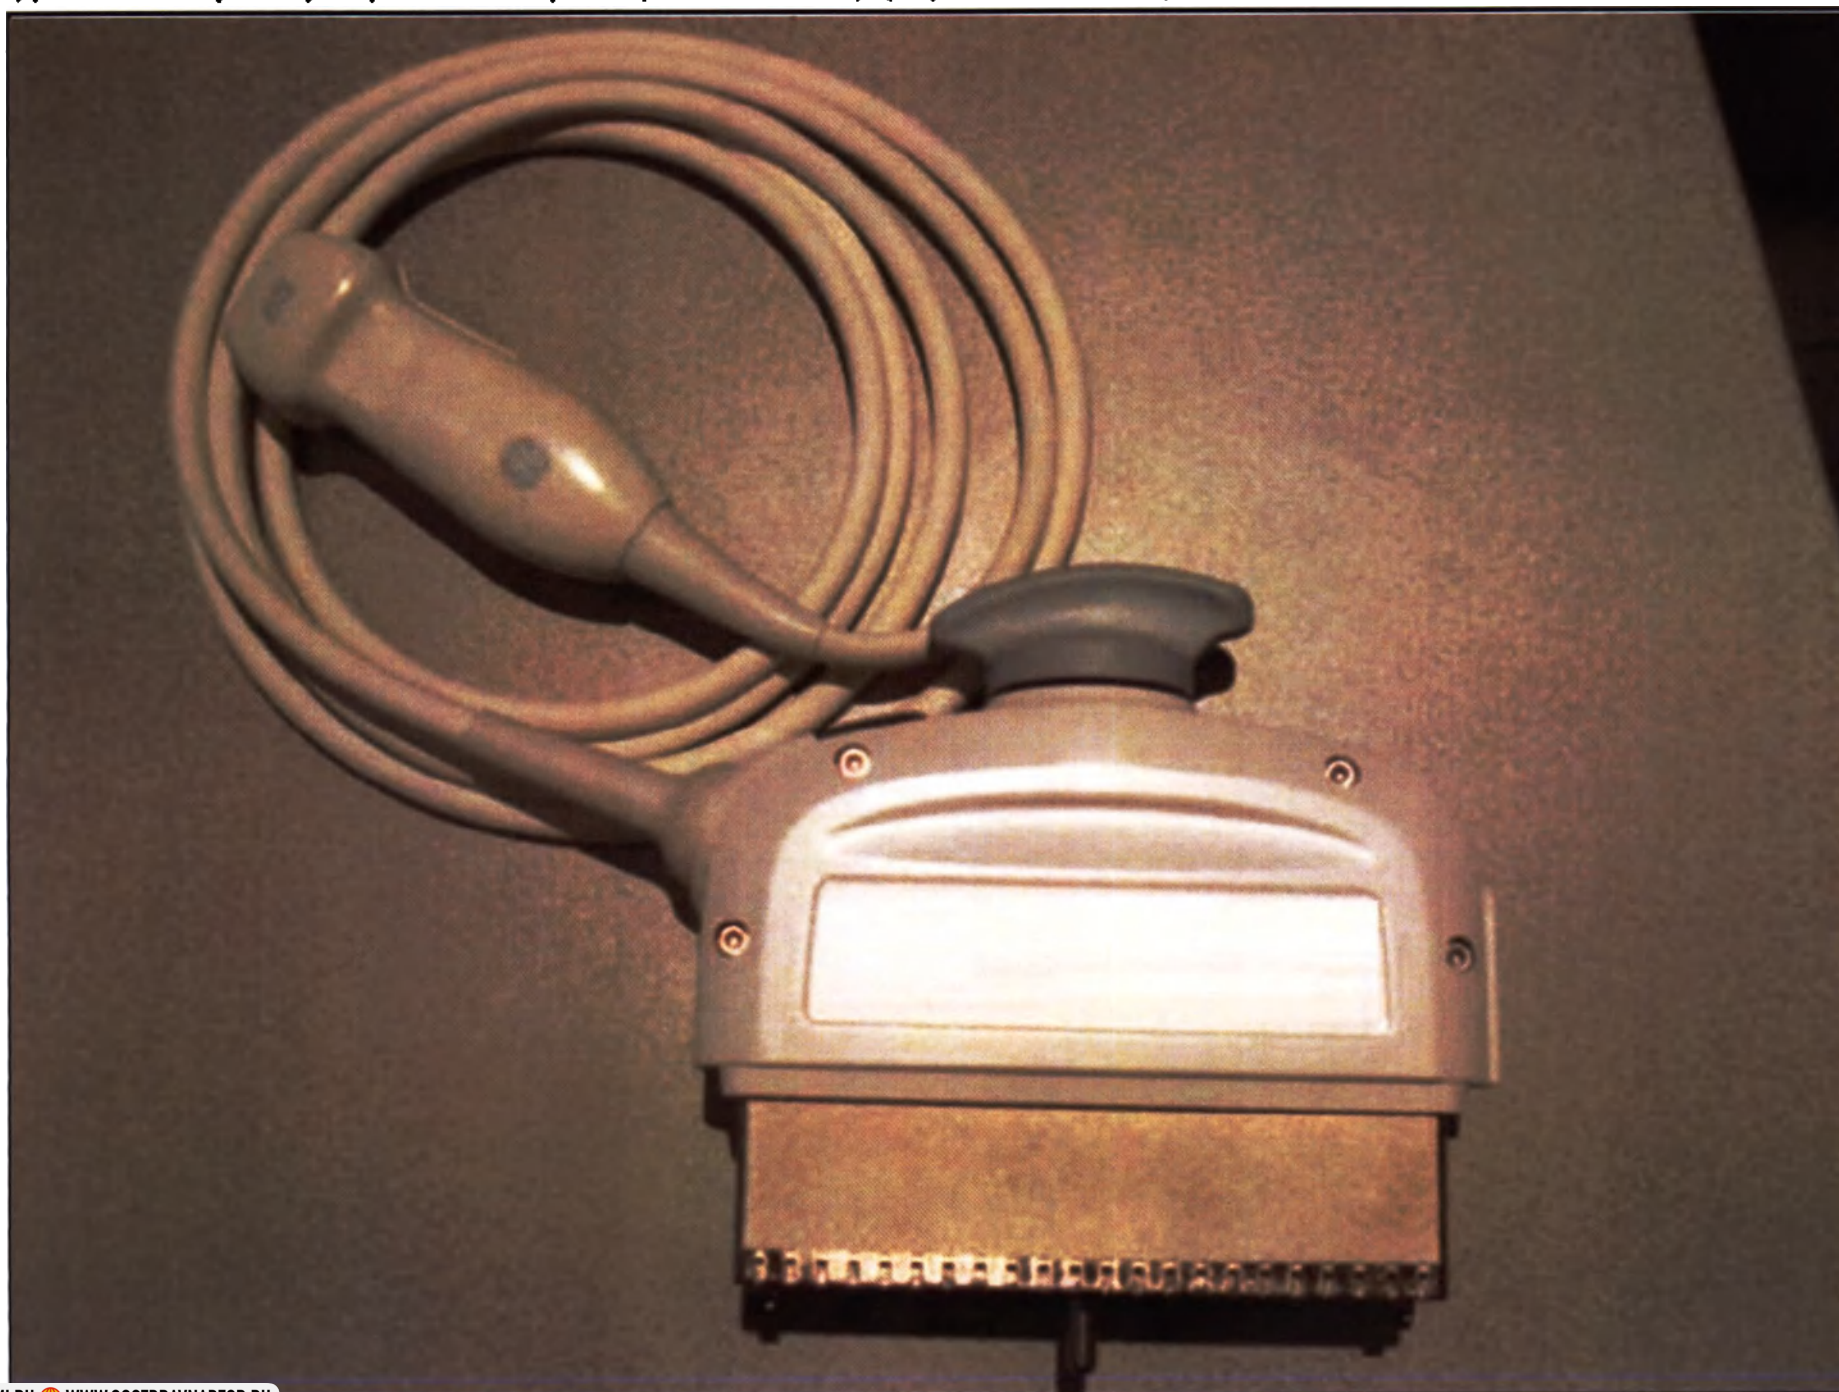

Адаптеры для проведения биопсий для секторных фазированных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для секторных фазированных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Адаптеры для проведения объемной навигации для секторных фазированных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)




Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R4)

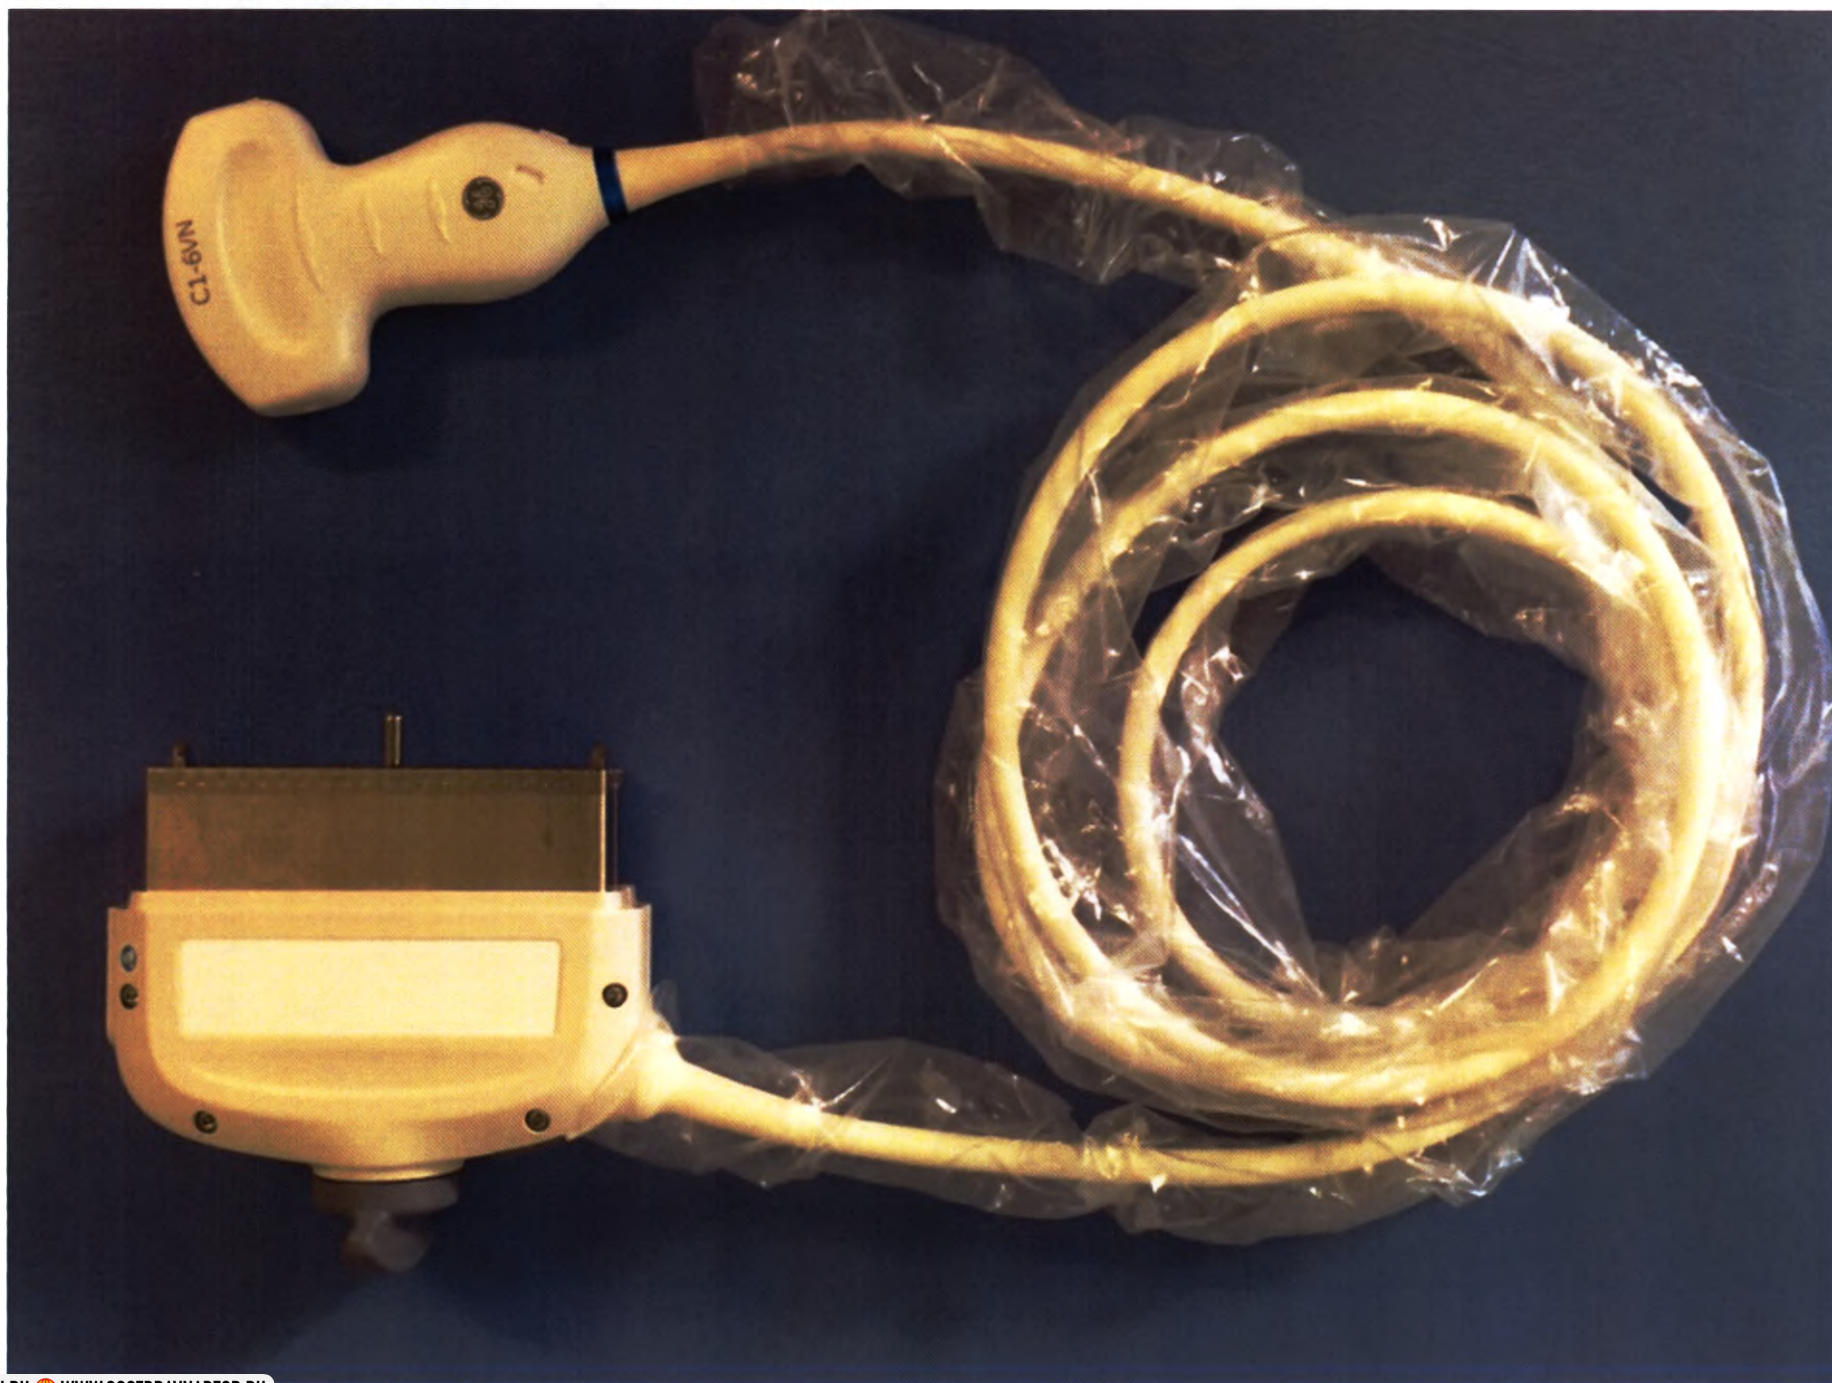

Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

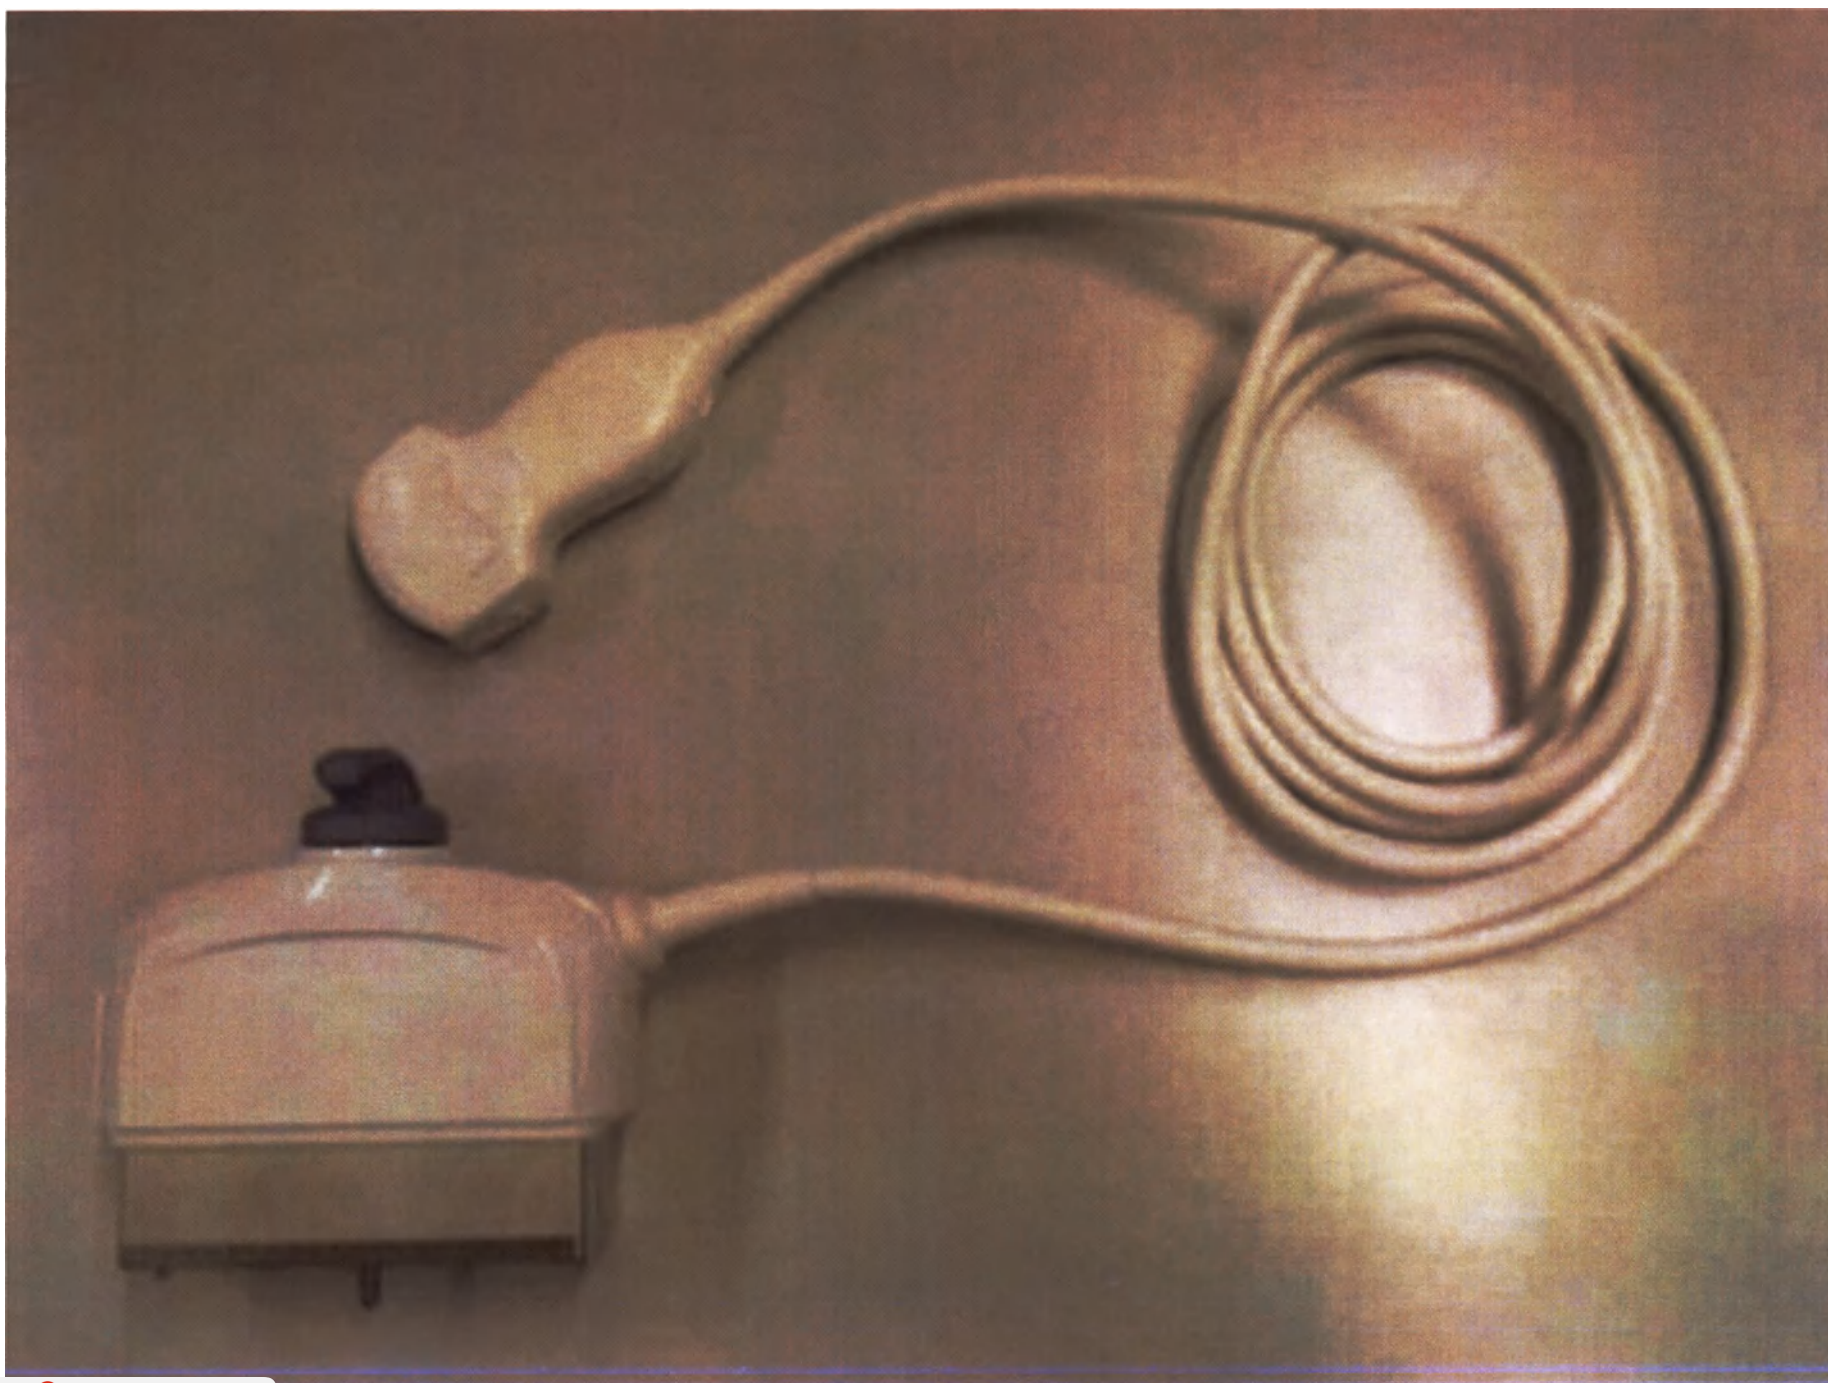

Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R4)

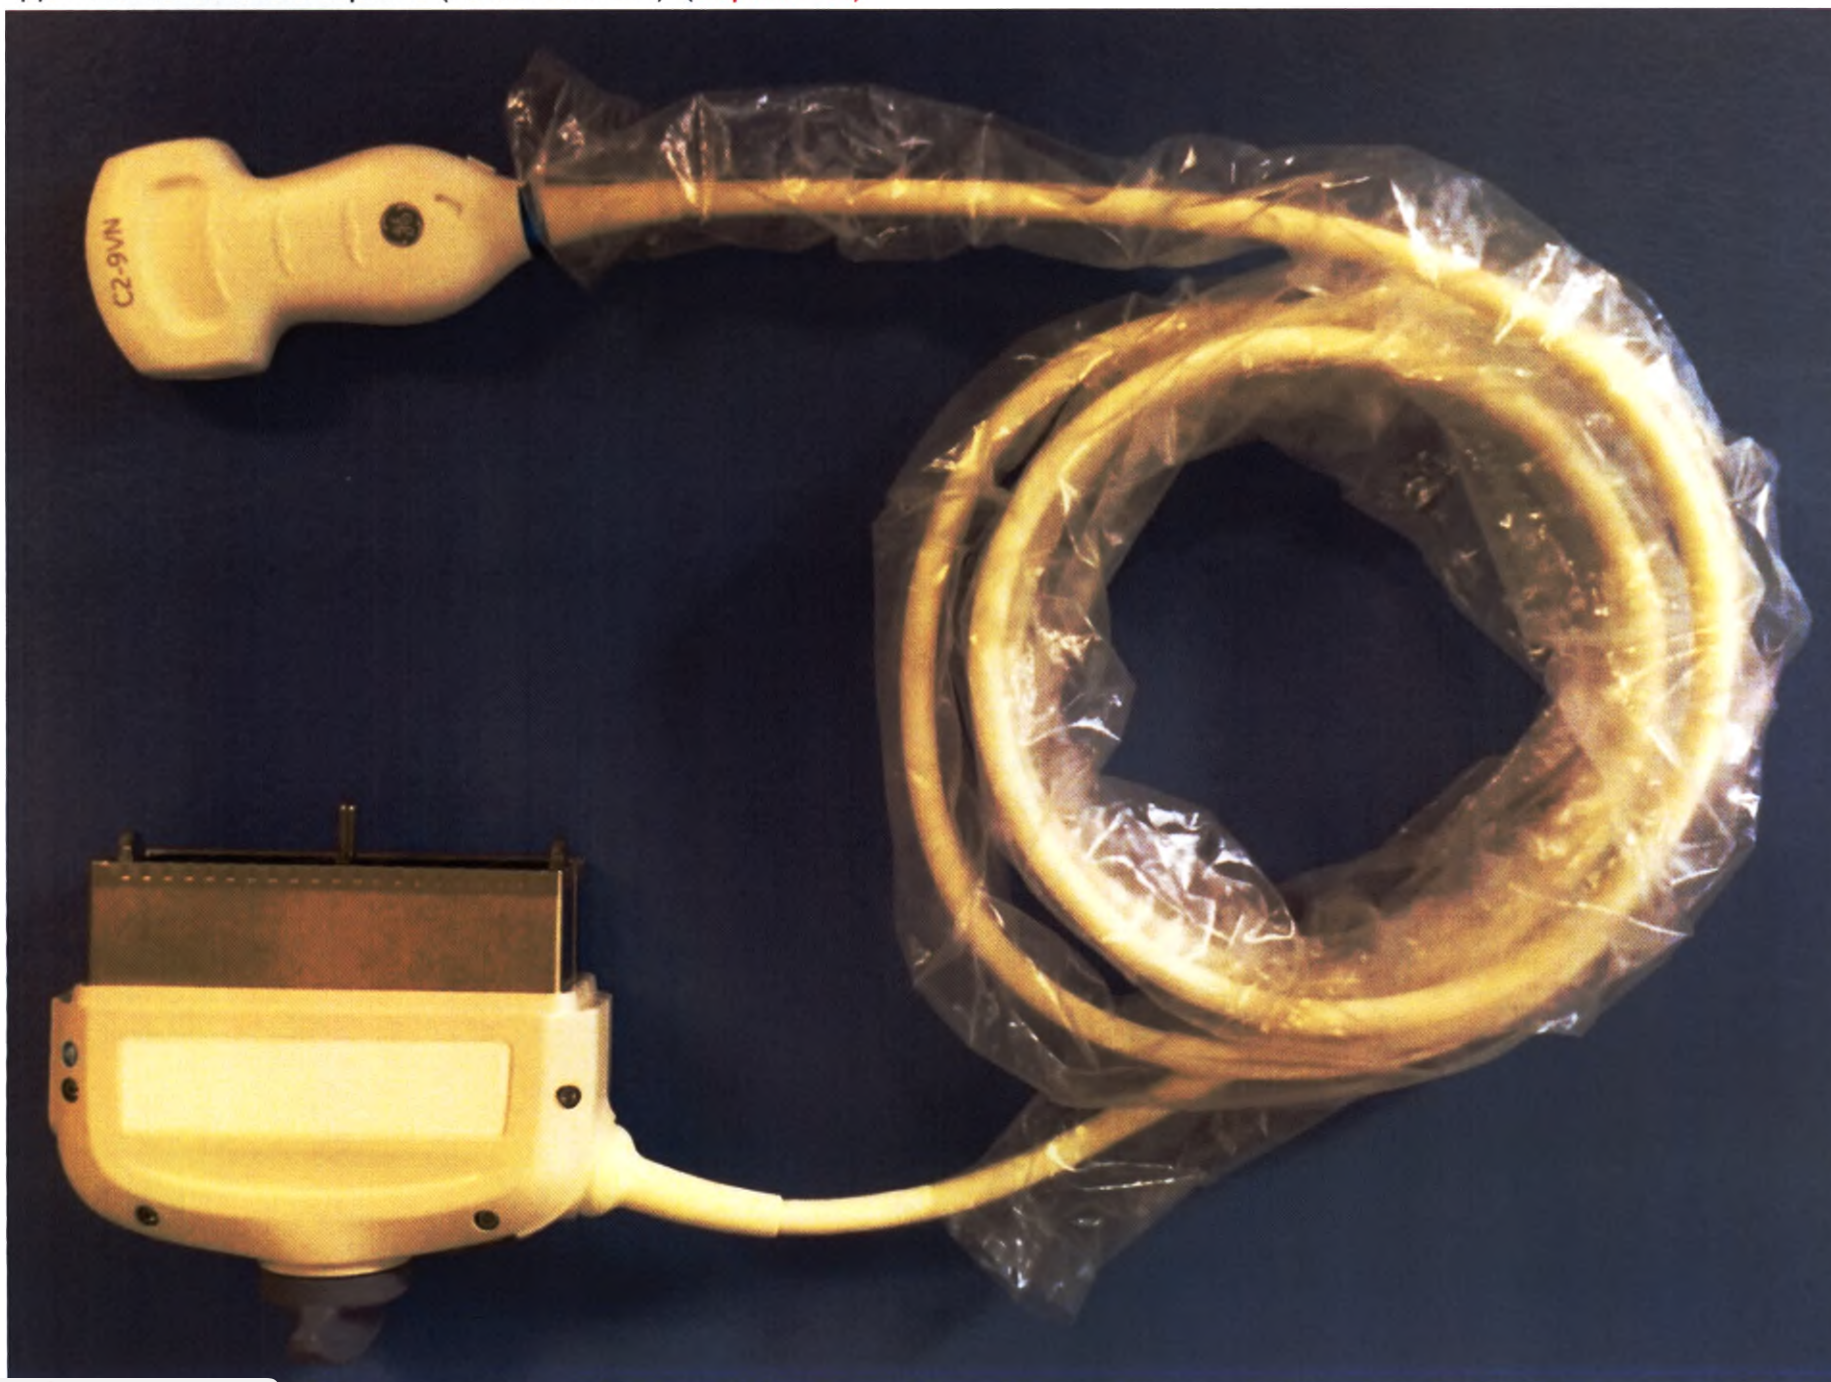

Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)




Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)




Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

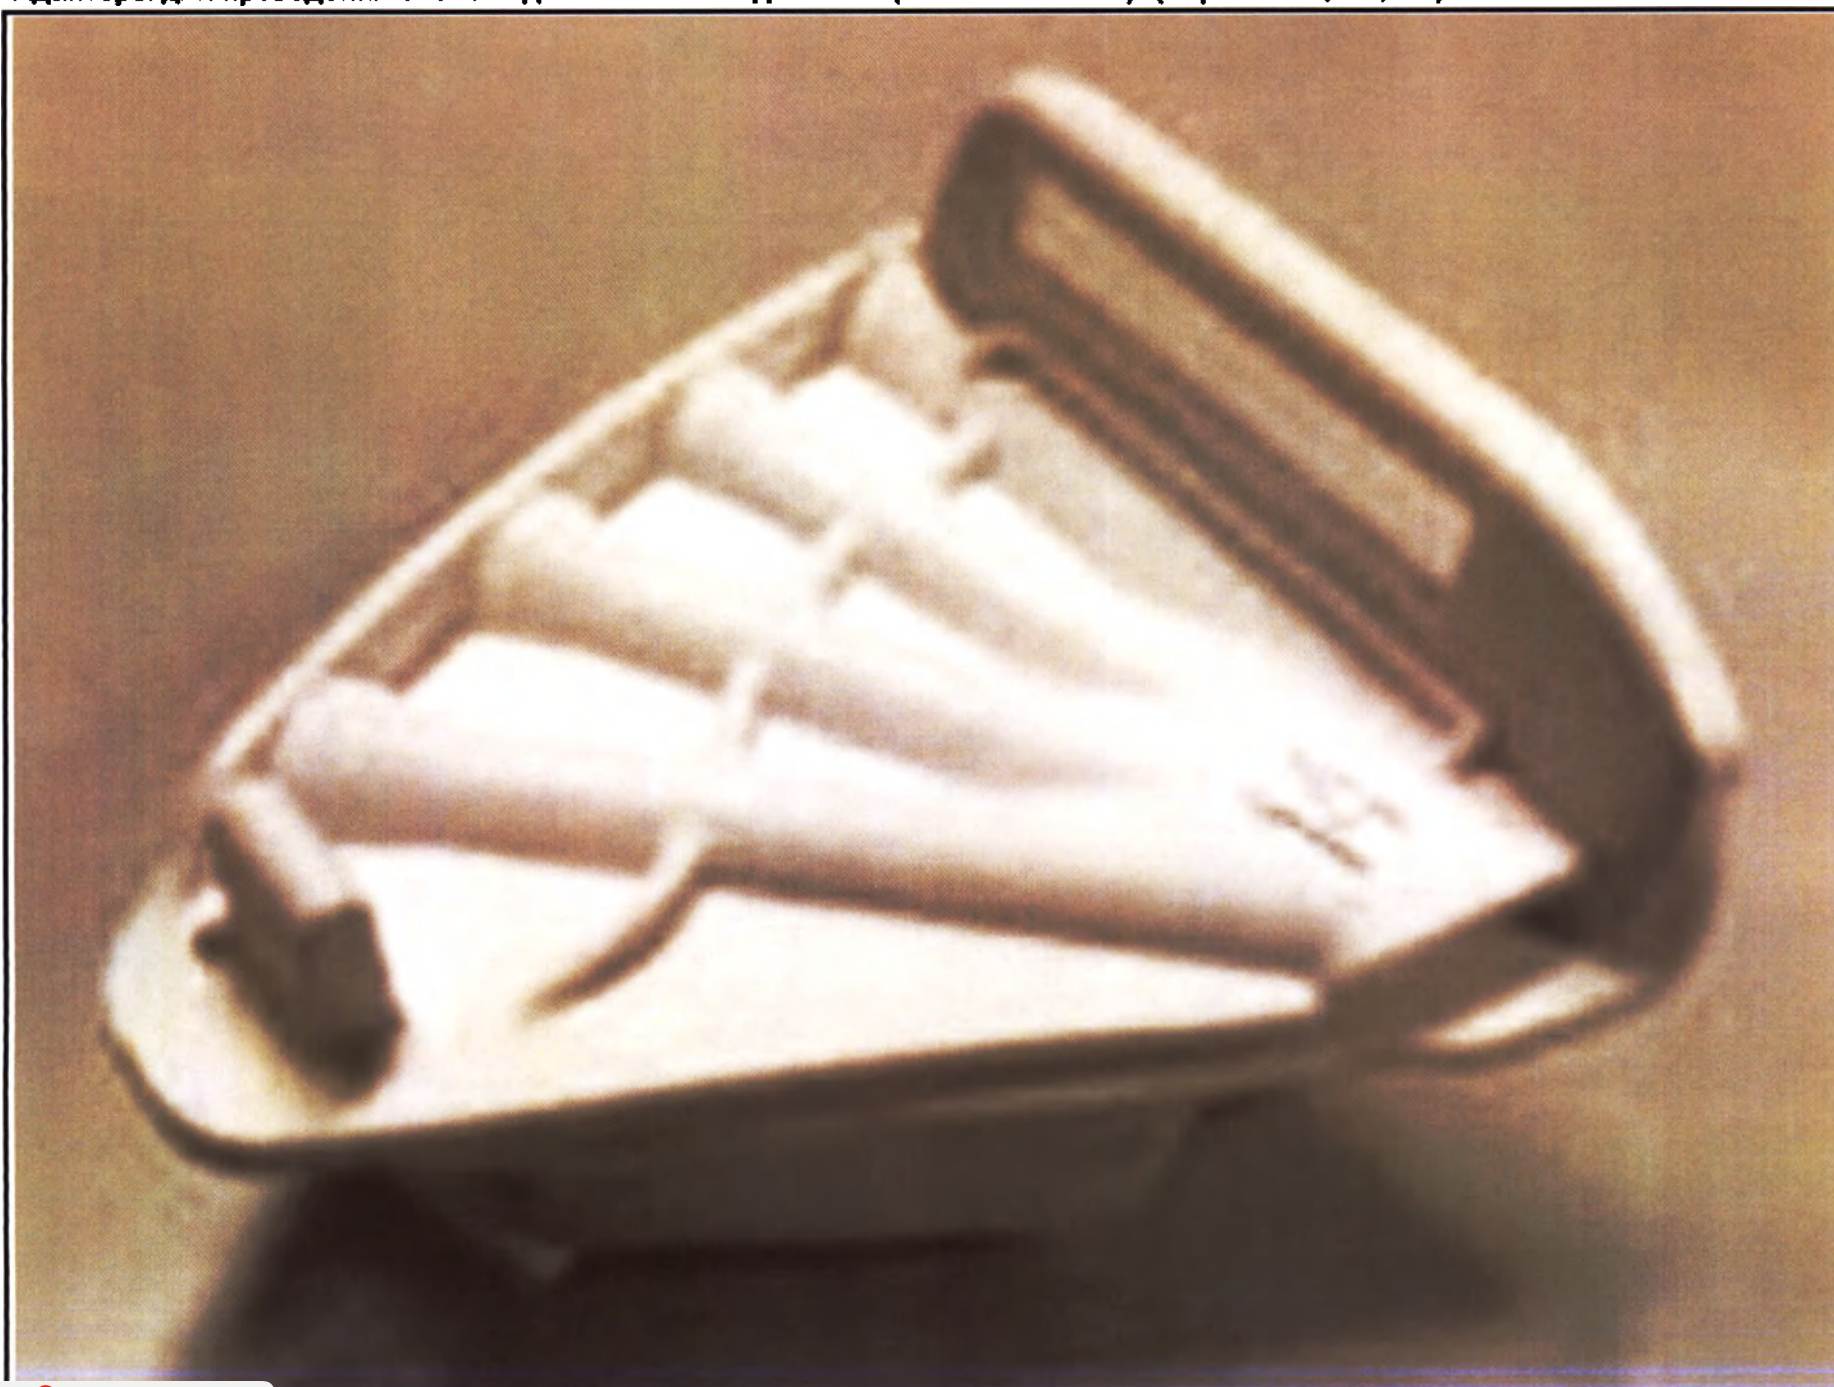


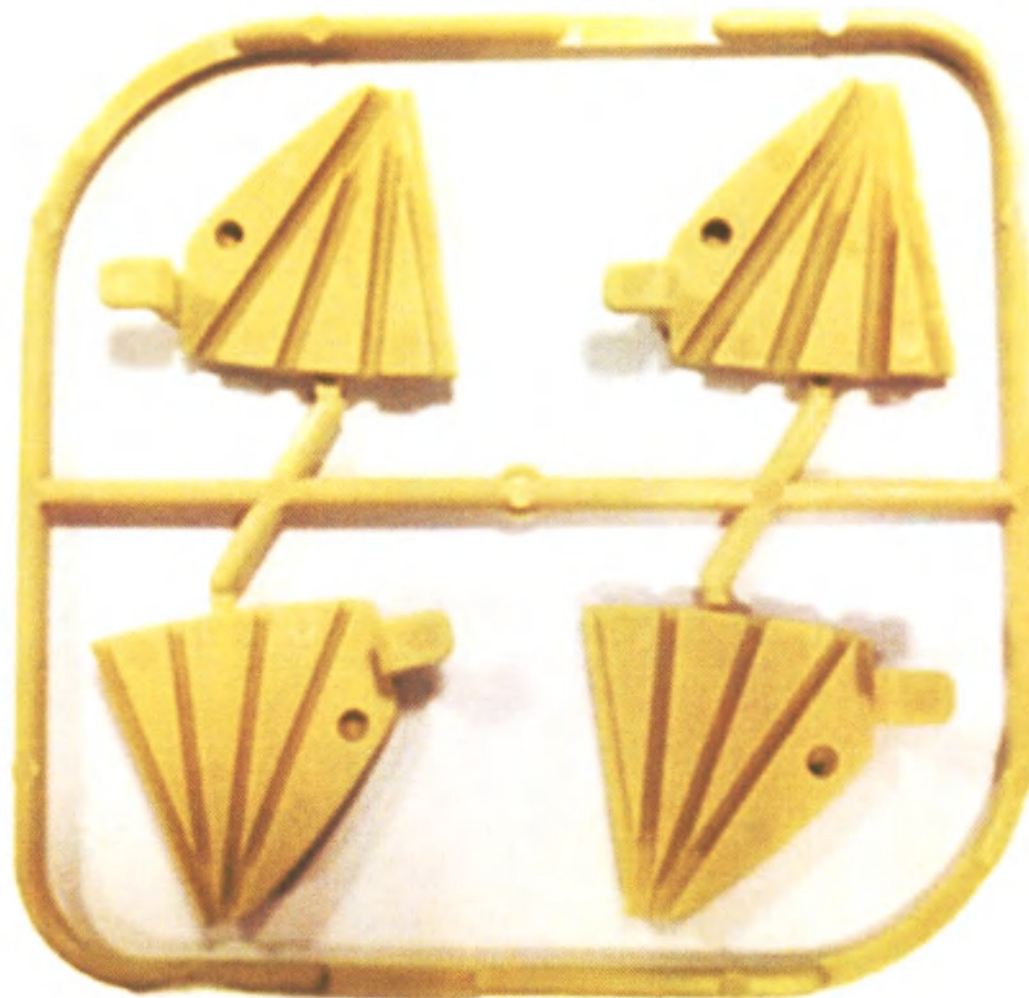

Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

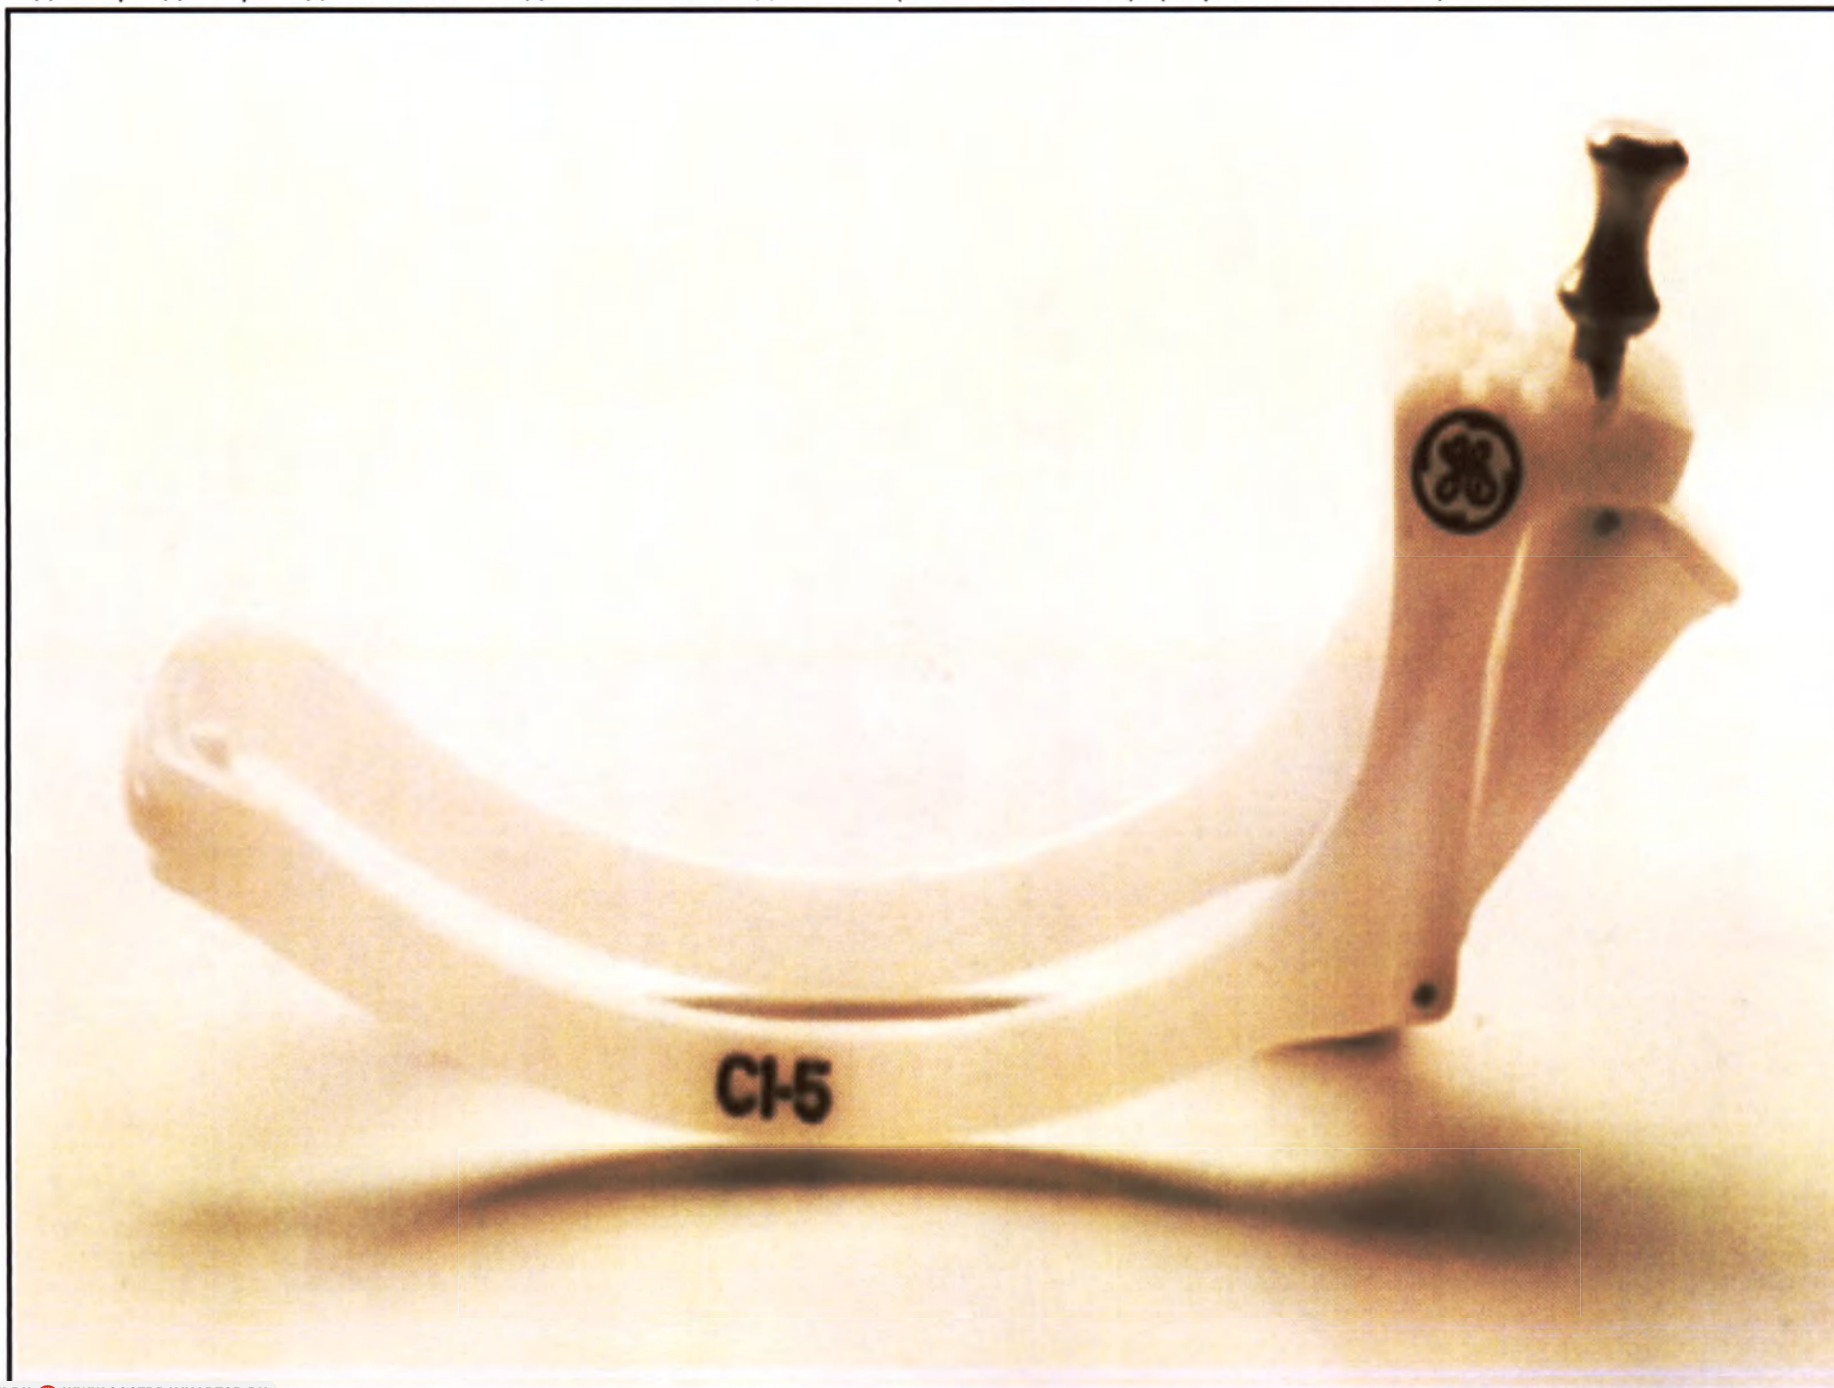


Адаптеры для проведения объемной навигации для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)




Адаптеры для проведения объемной навигации для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

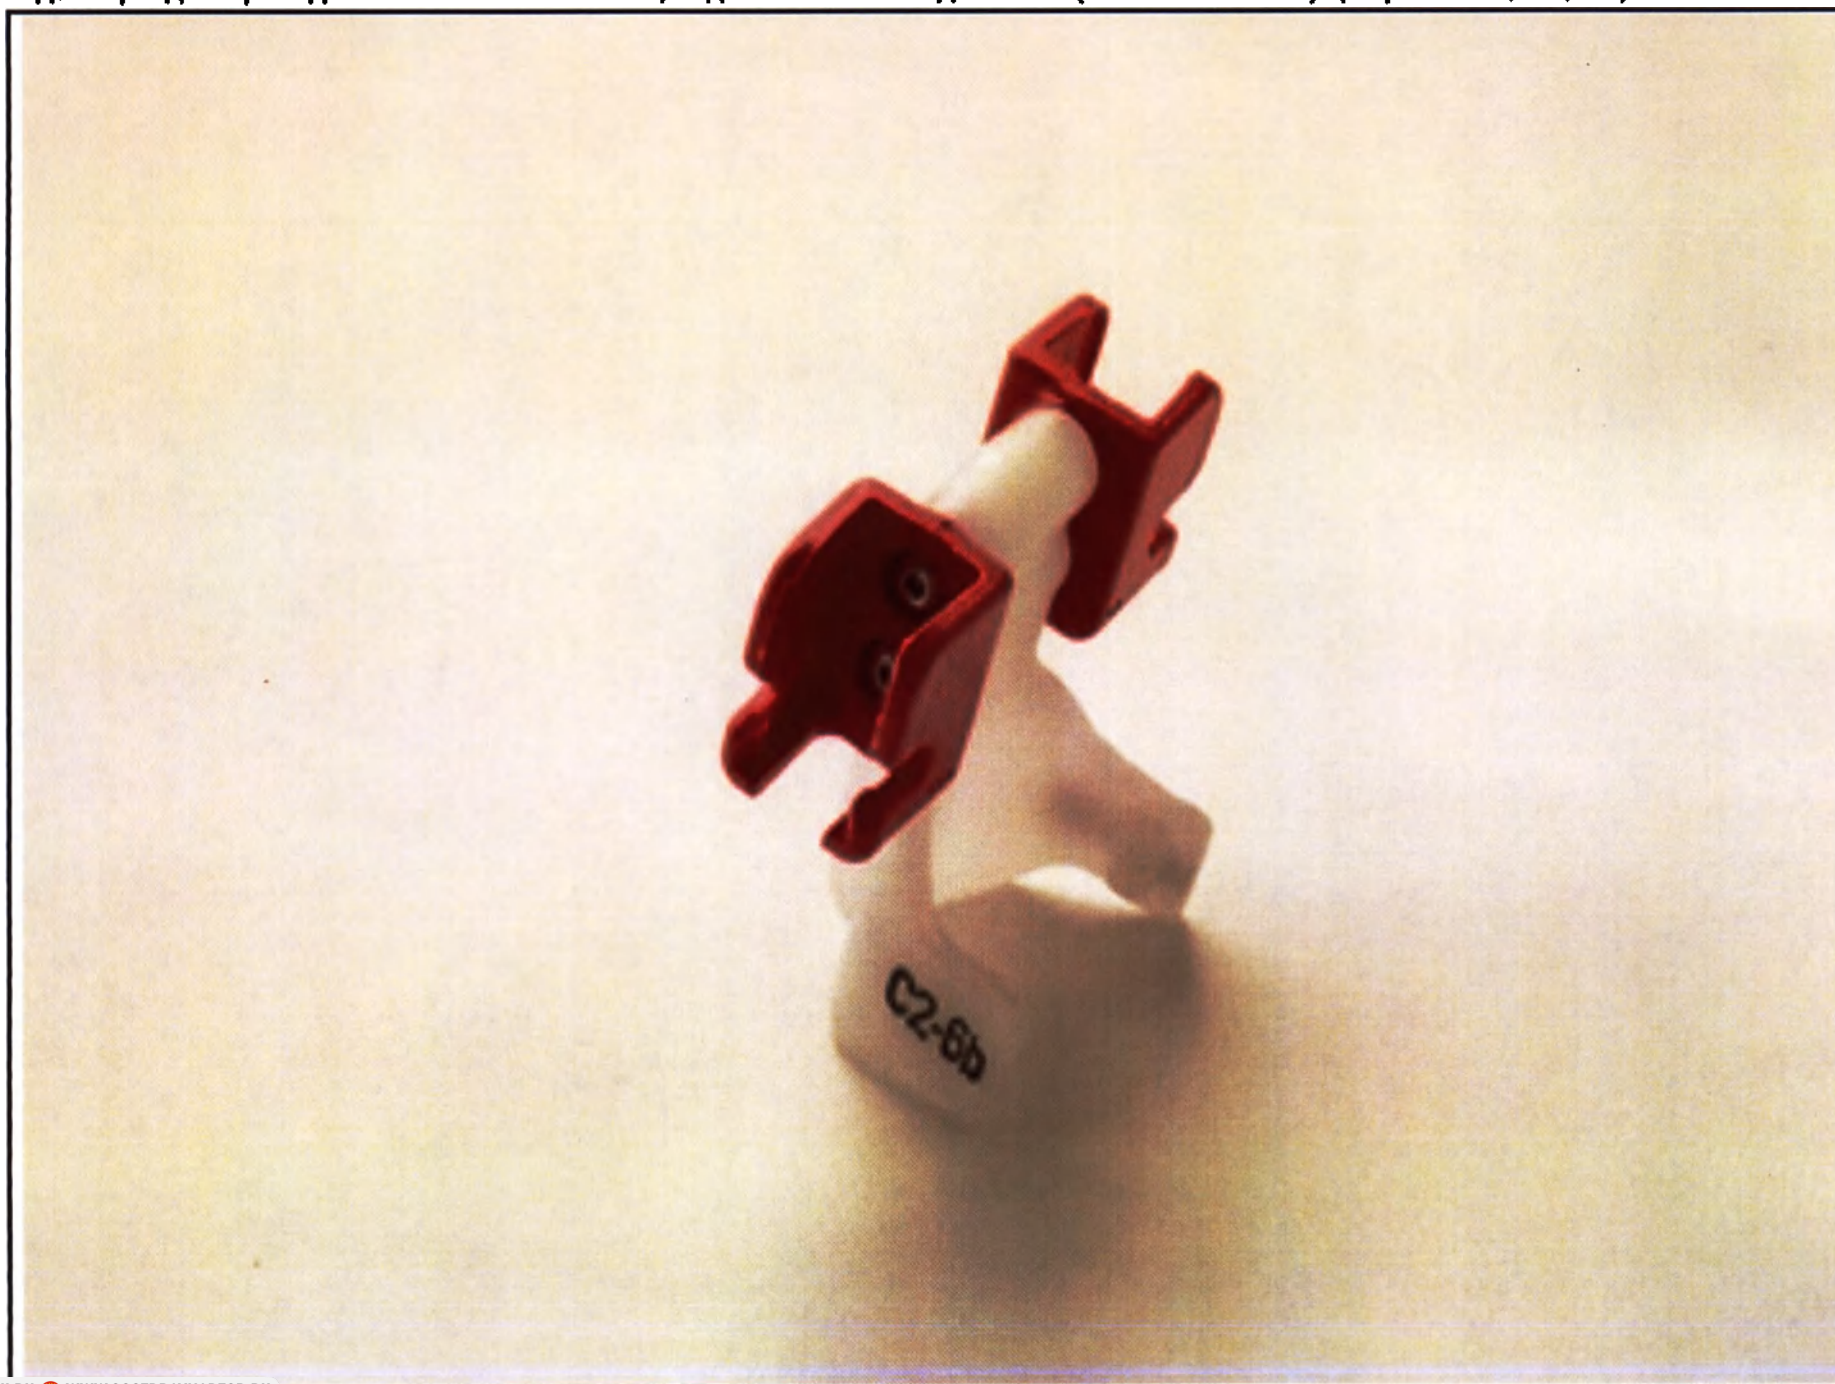


Адаптеры для проведения объемной навигации для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

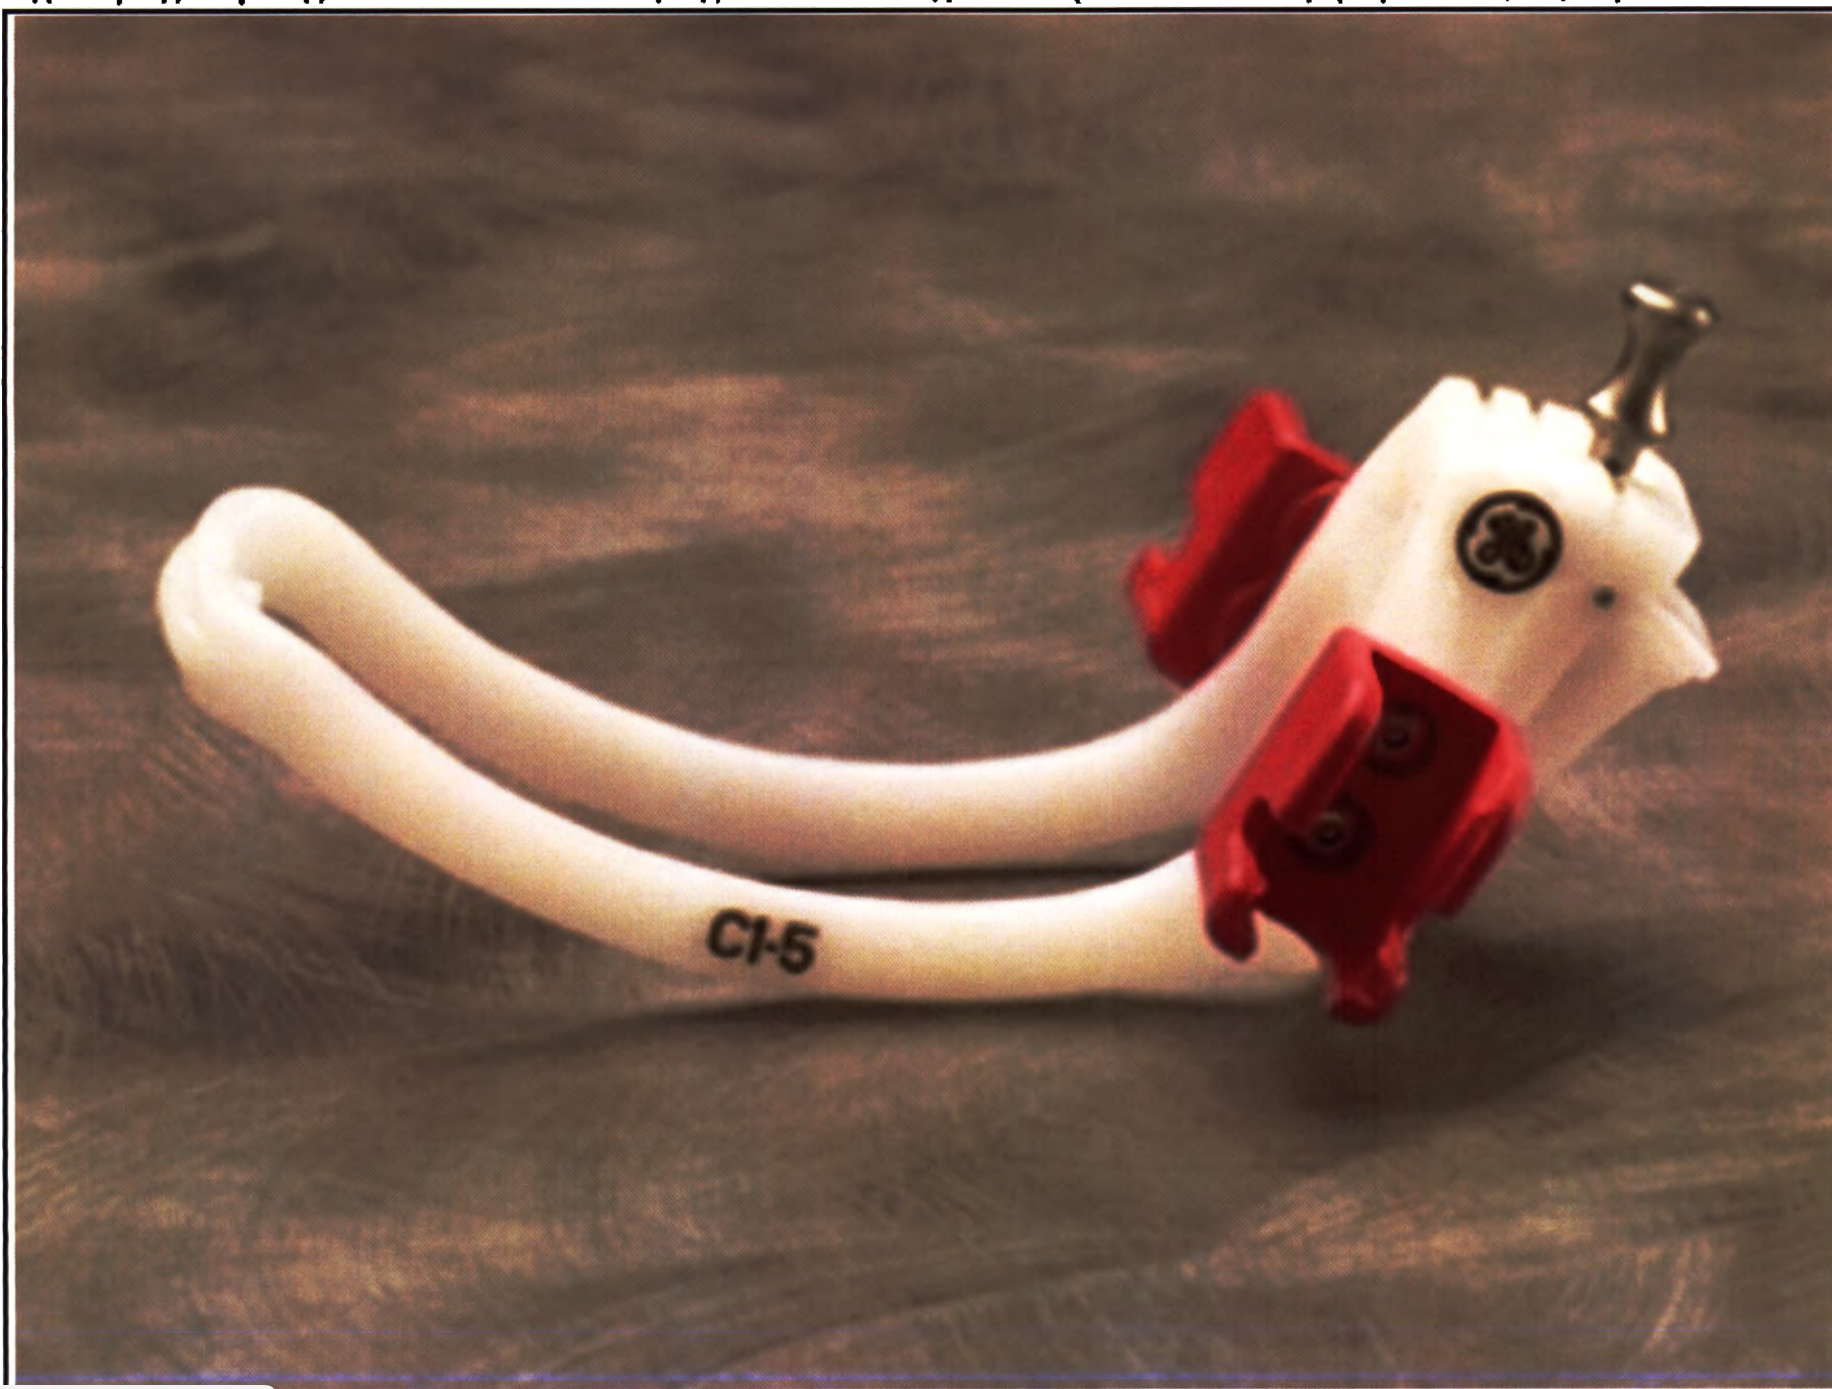


Адаптеры для проведения объемной навигации для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для конвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)

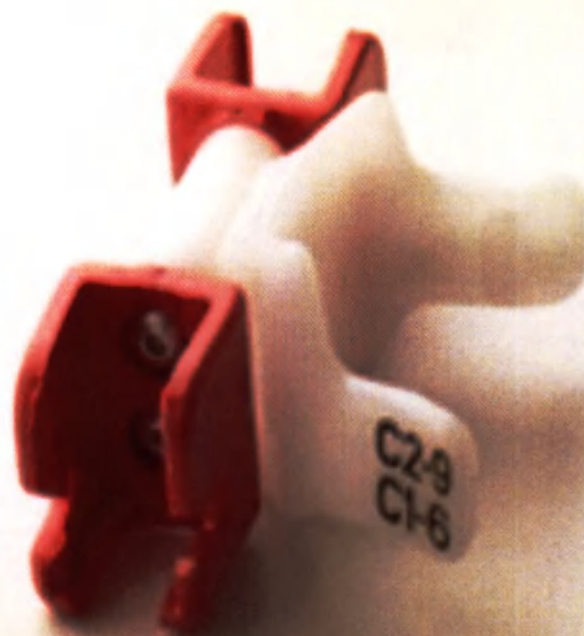

Датчики линейные серии L (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)

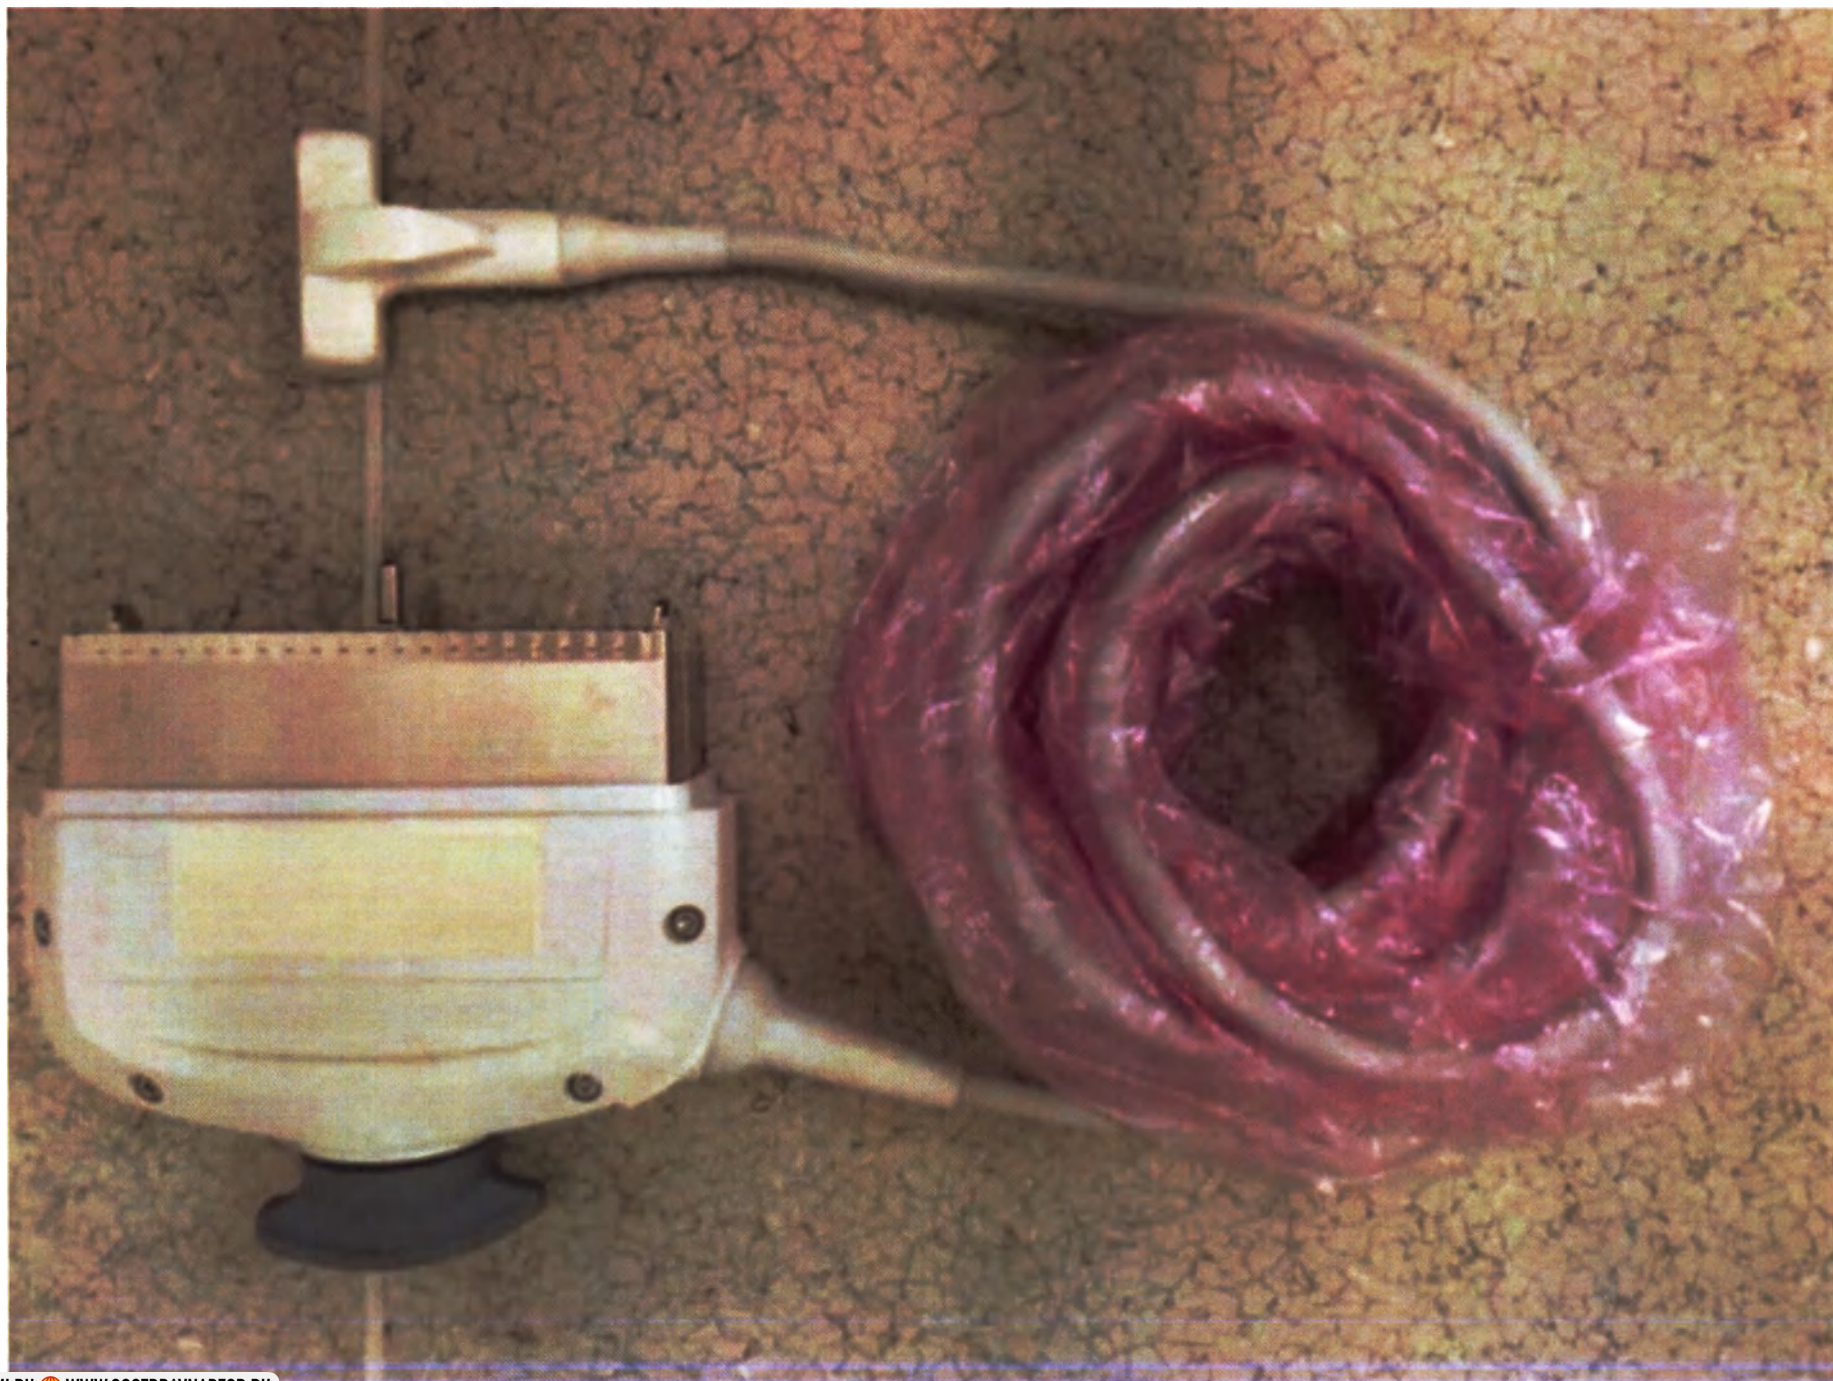


Датчики линейные серии L (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)



Датчики линейные серии L (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики линейные серии L (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

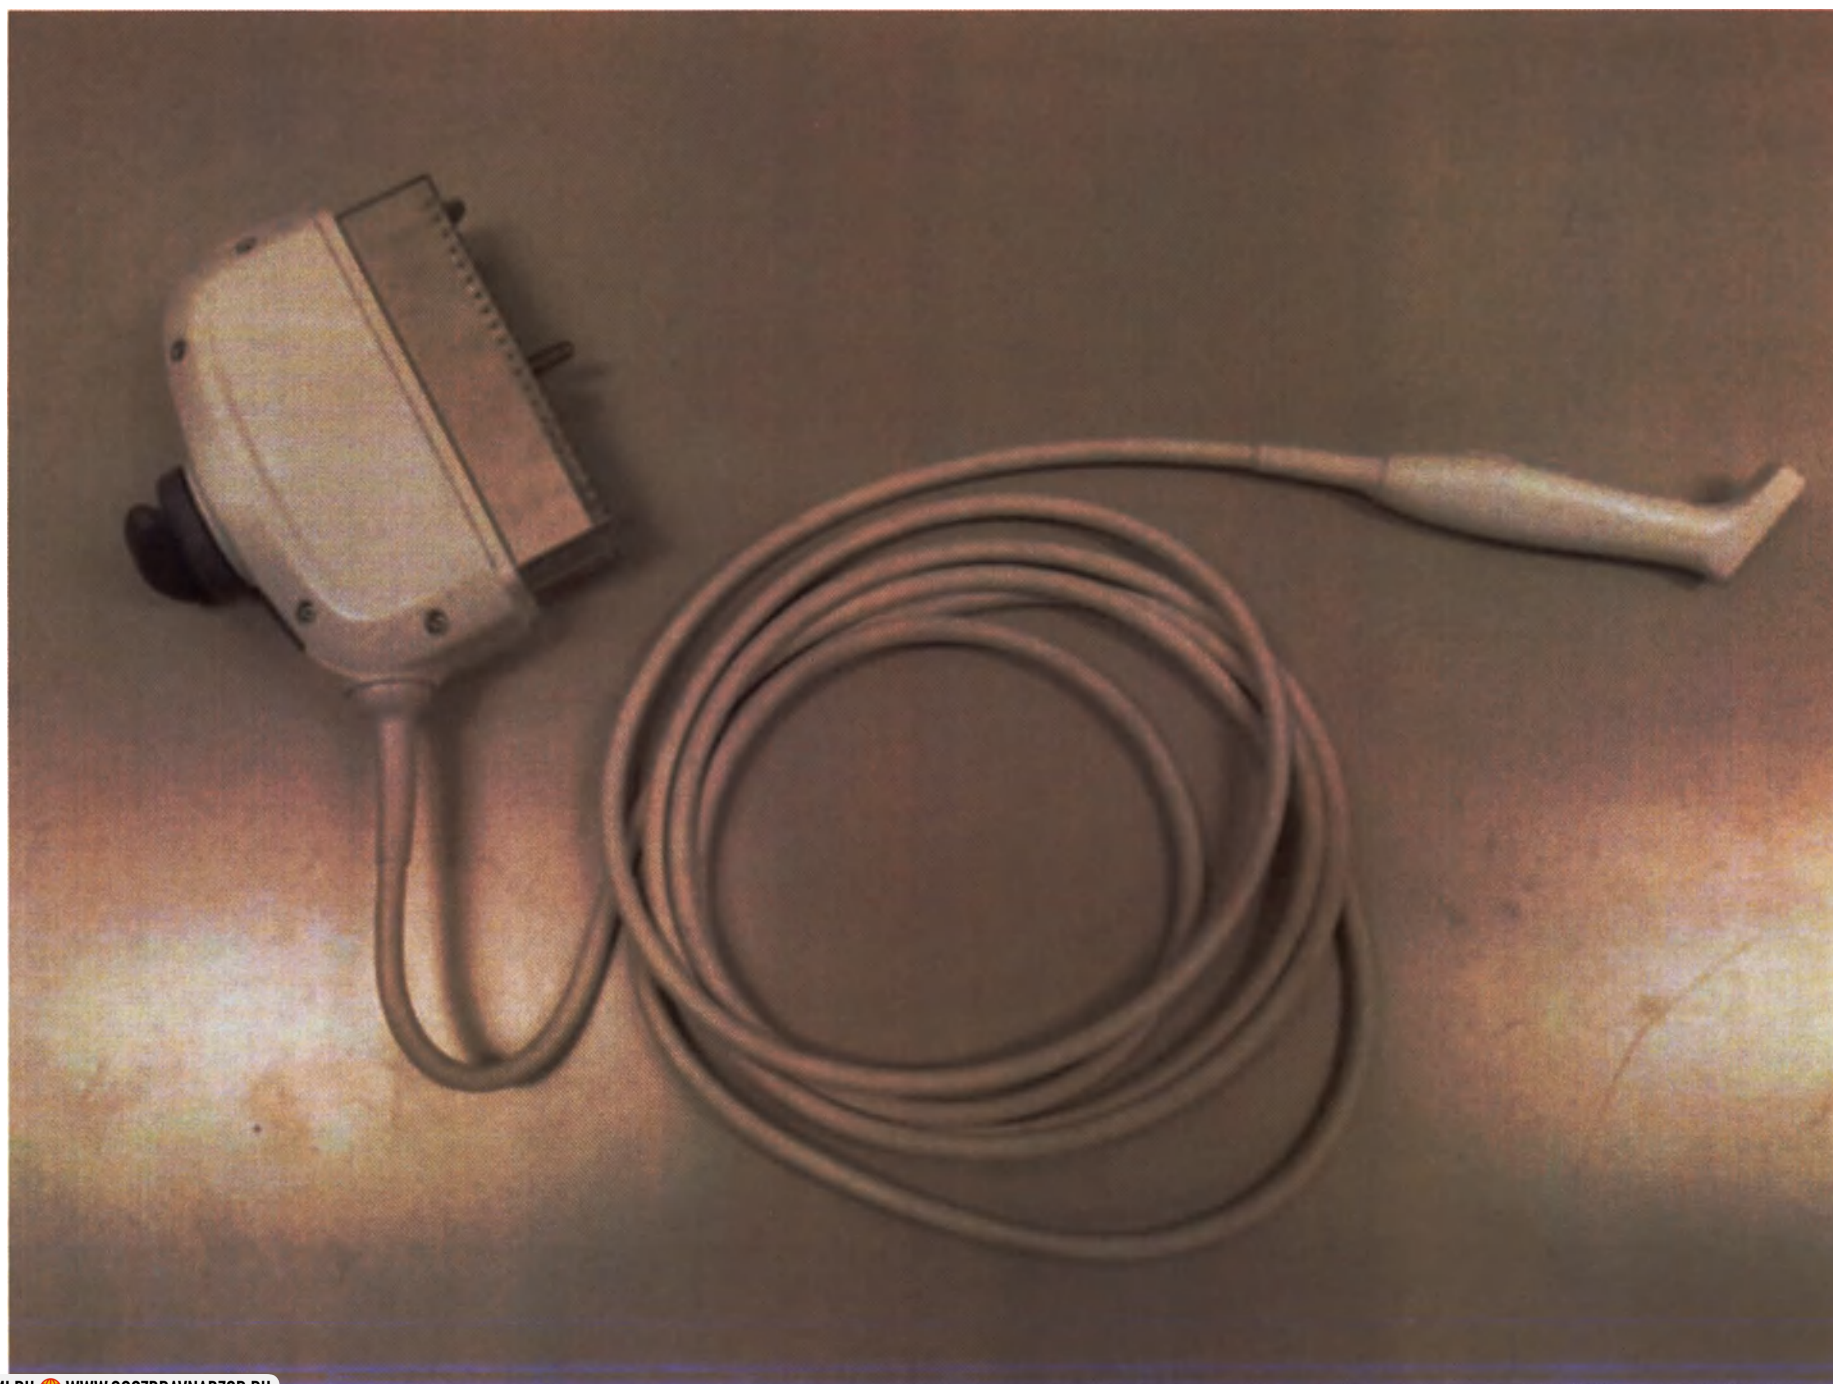

Датчики линейные серии L (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)





Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

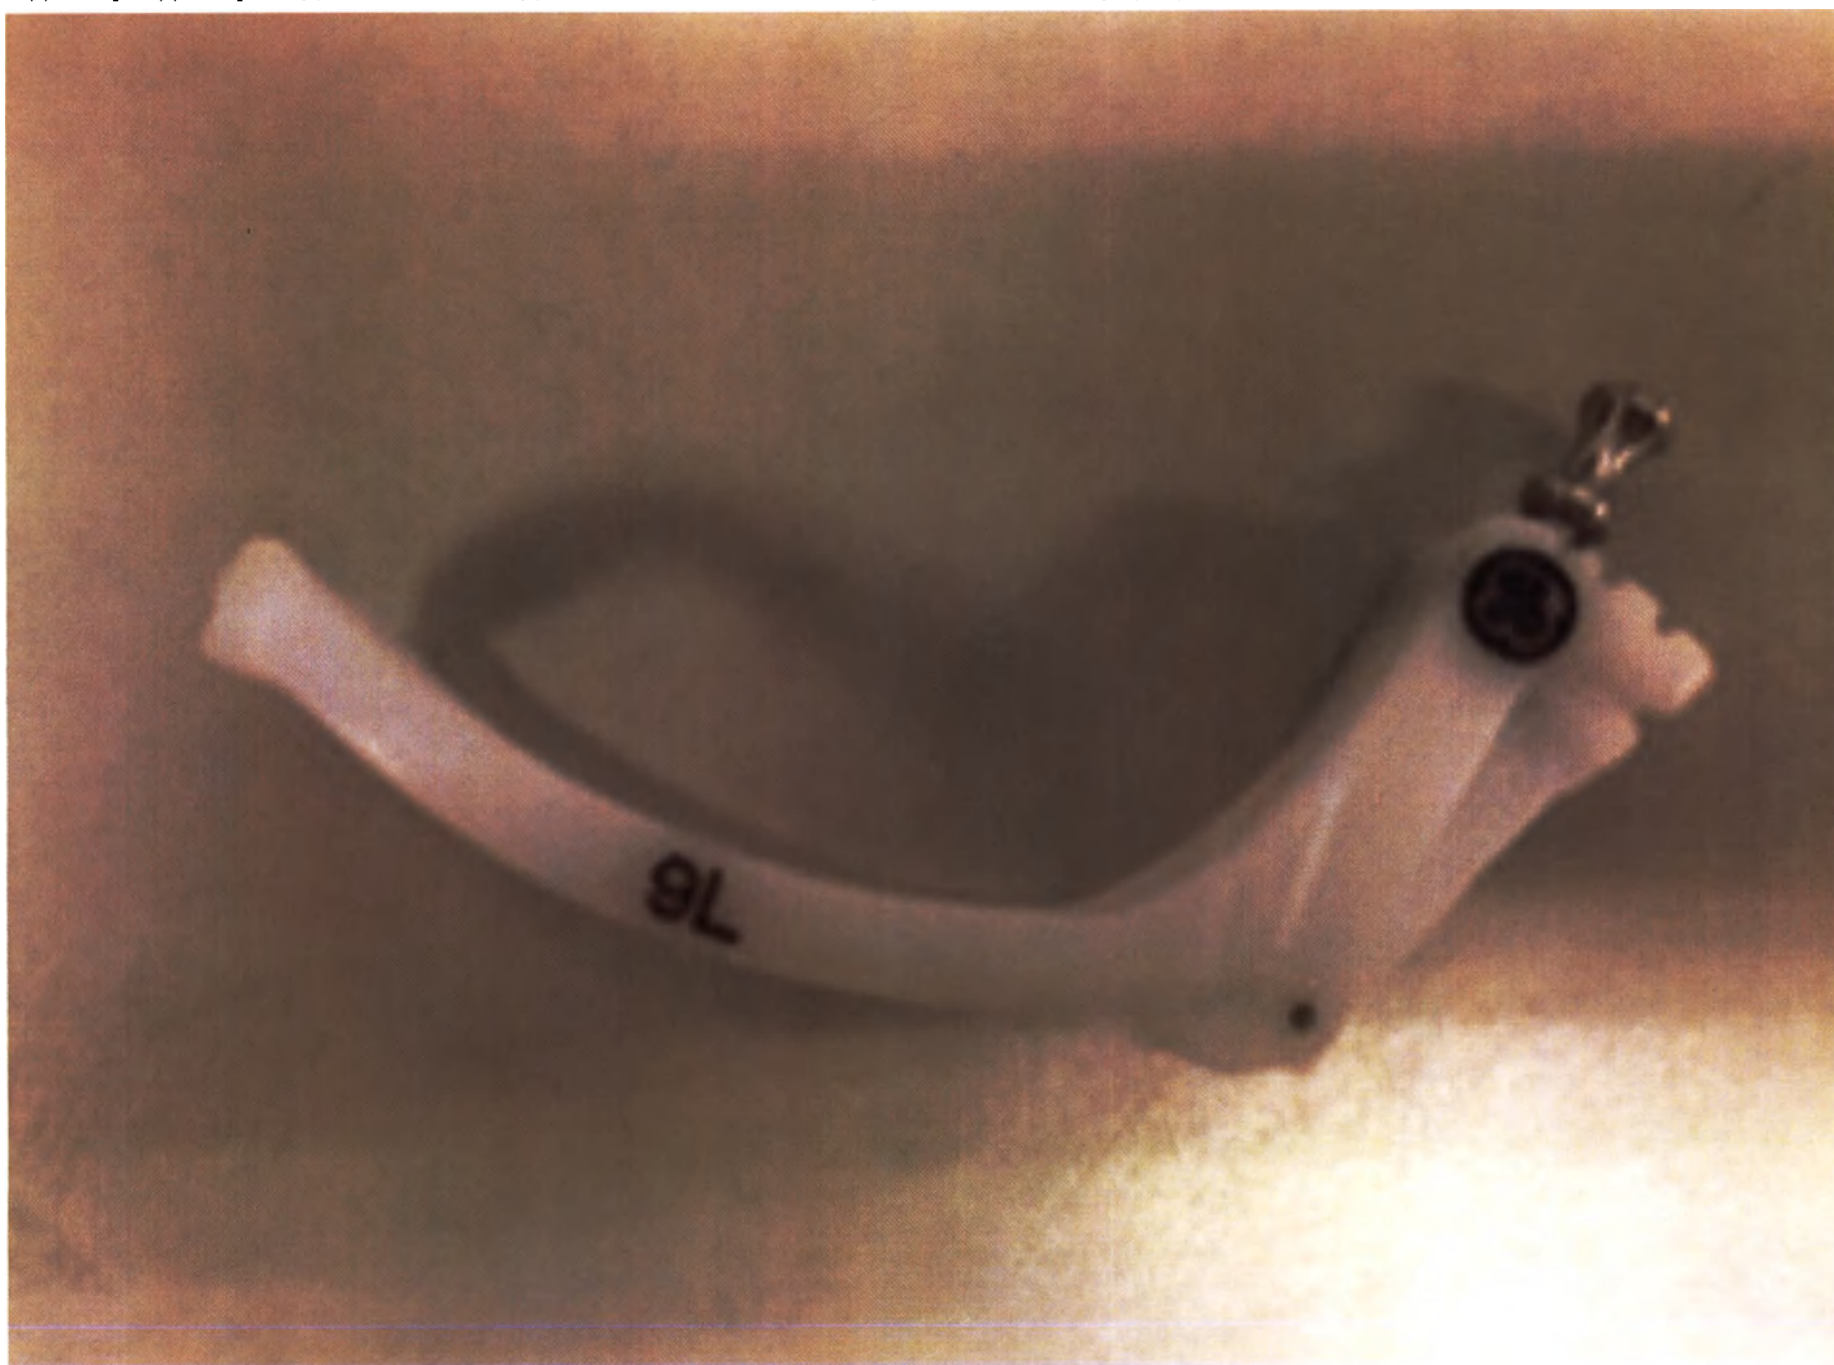

Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для линейных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Датчики микроконвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики микроконвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)



Датчики микроконвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)

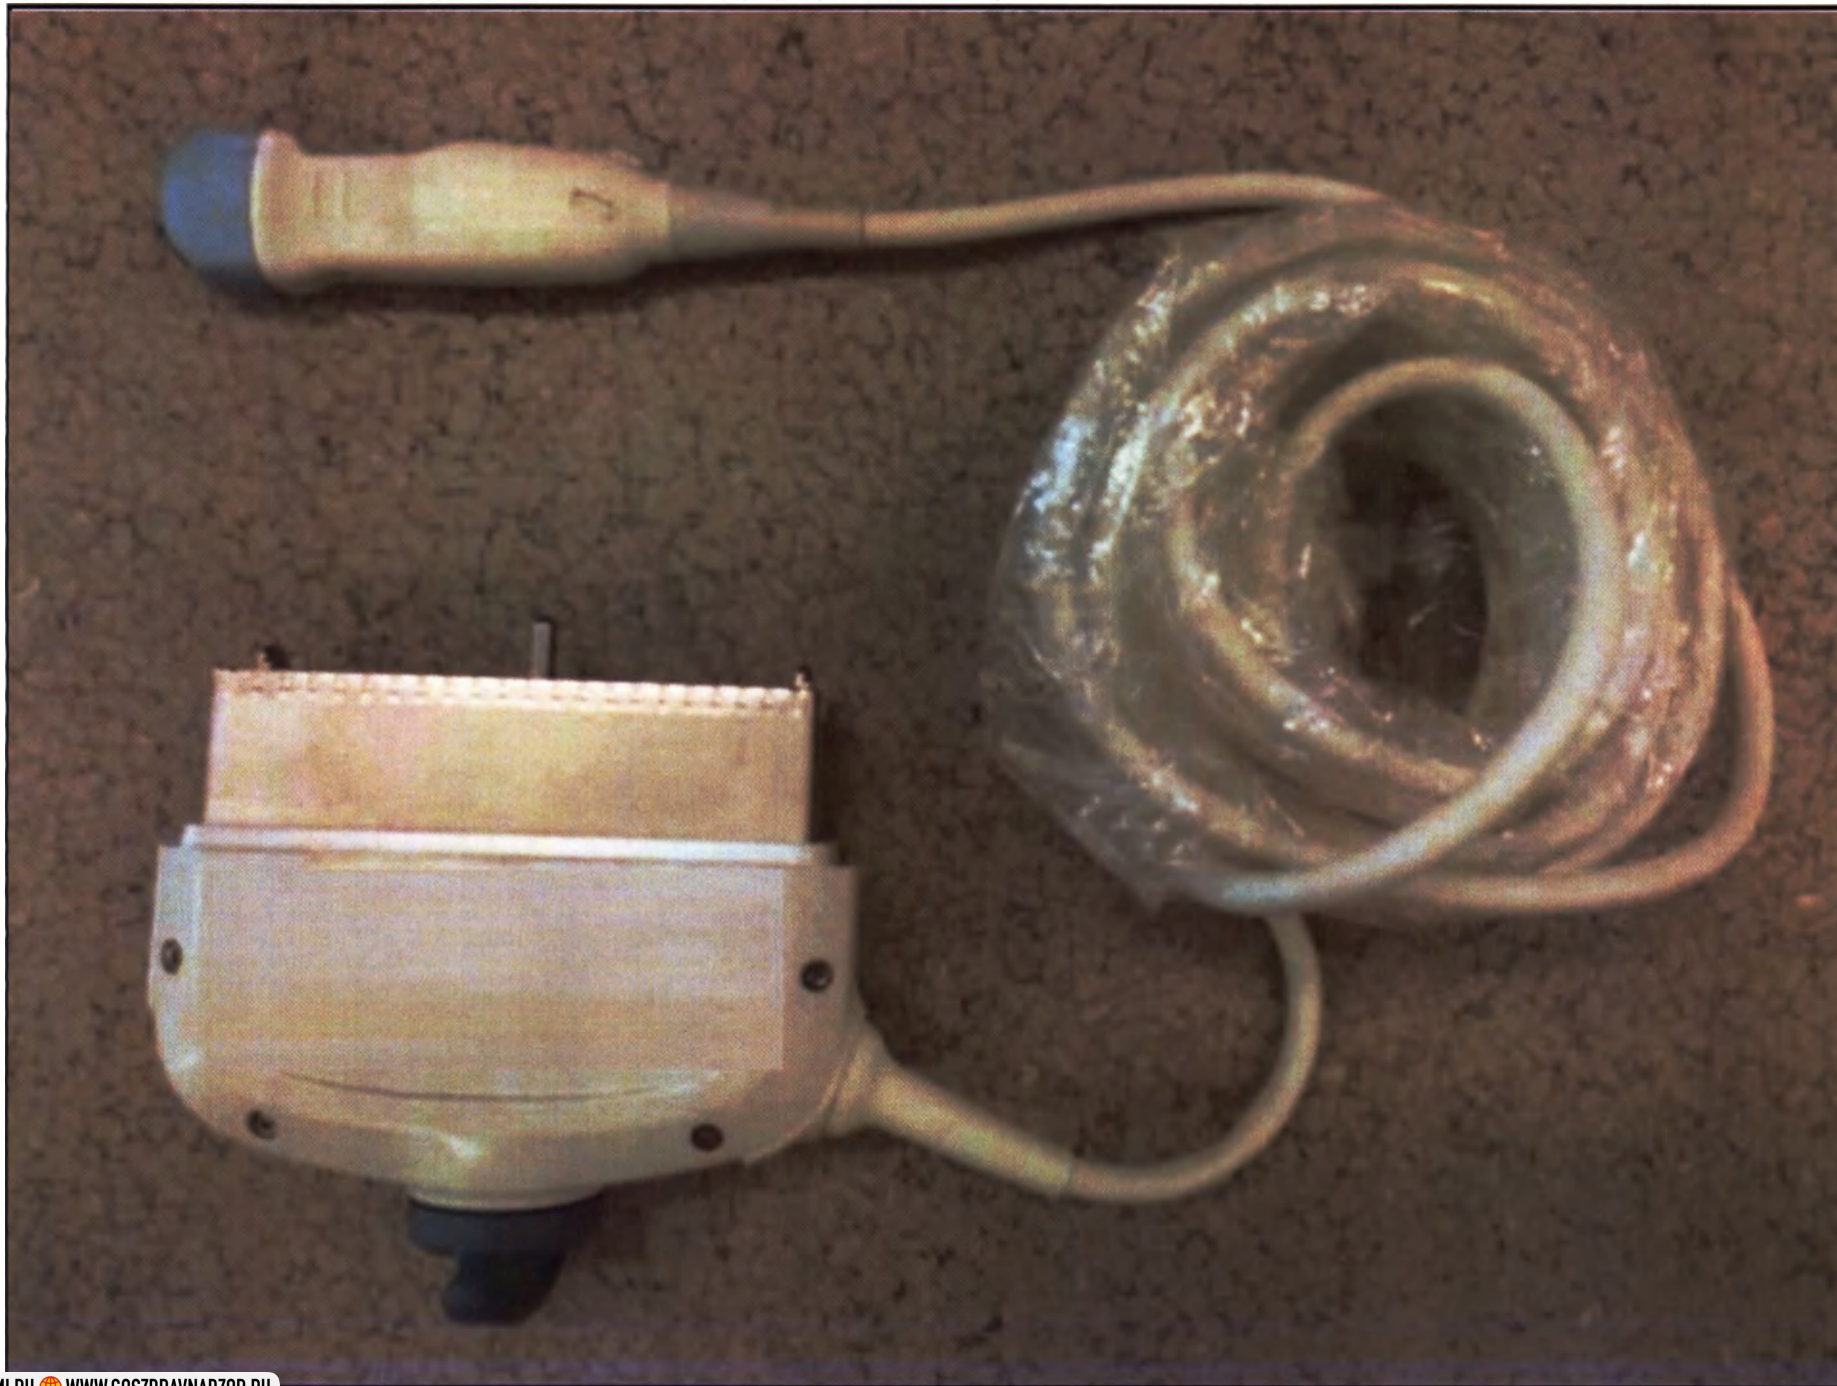

Датчики микроконвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R4)




Датчики микроконвексные серии С (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики микроконвексные серии IC (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики микроконвексные серии ВЕ (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)

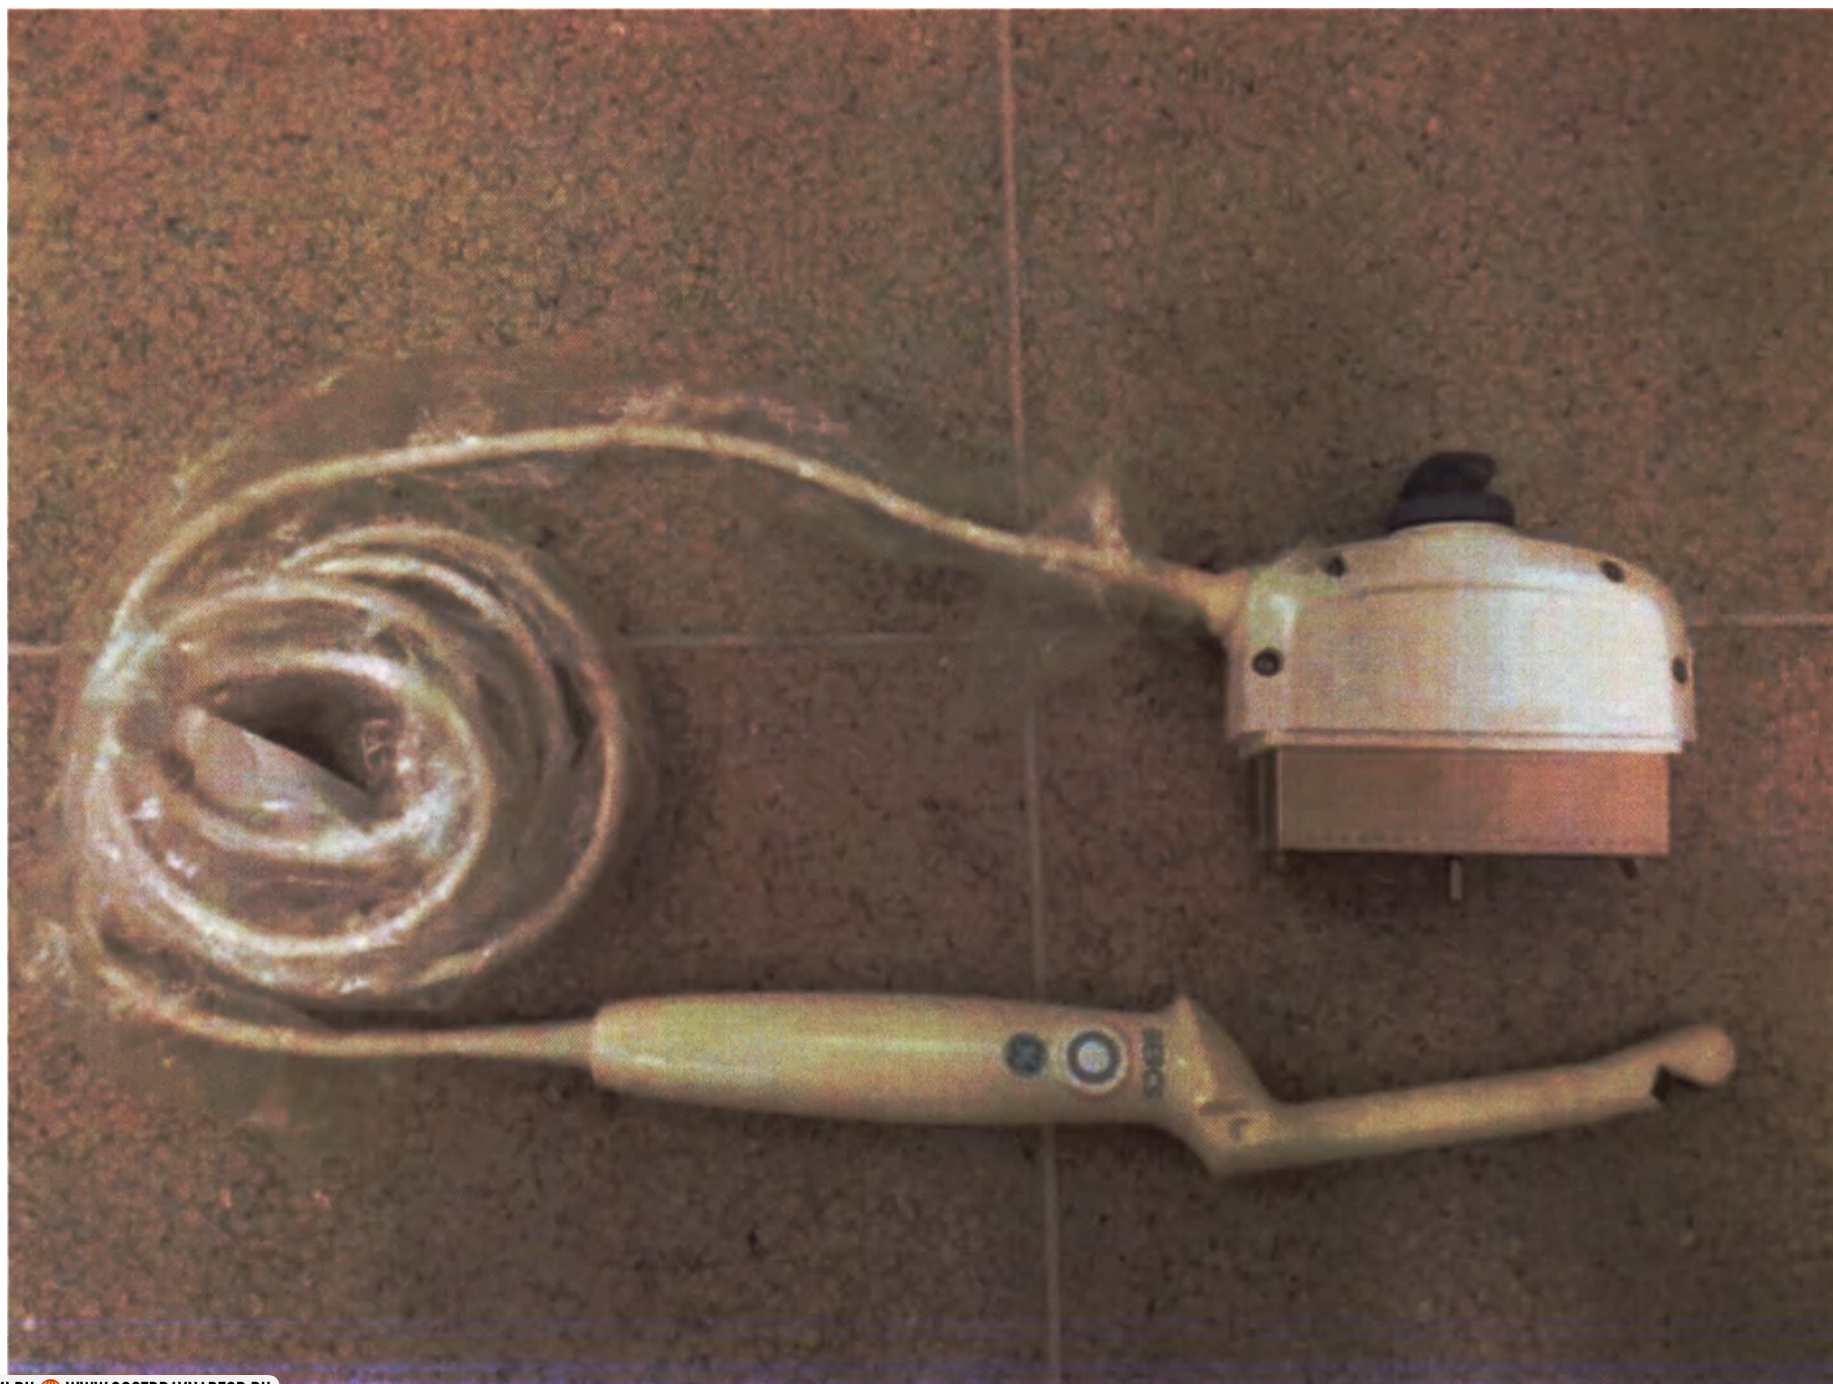

Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R3, R4)




Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R3, R4)

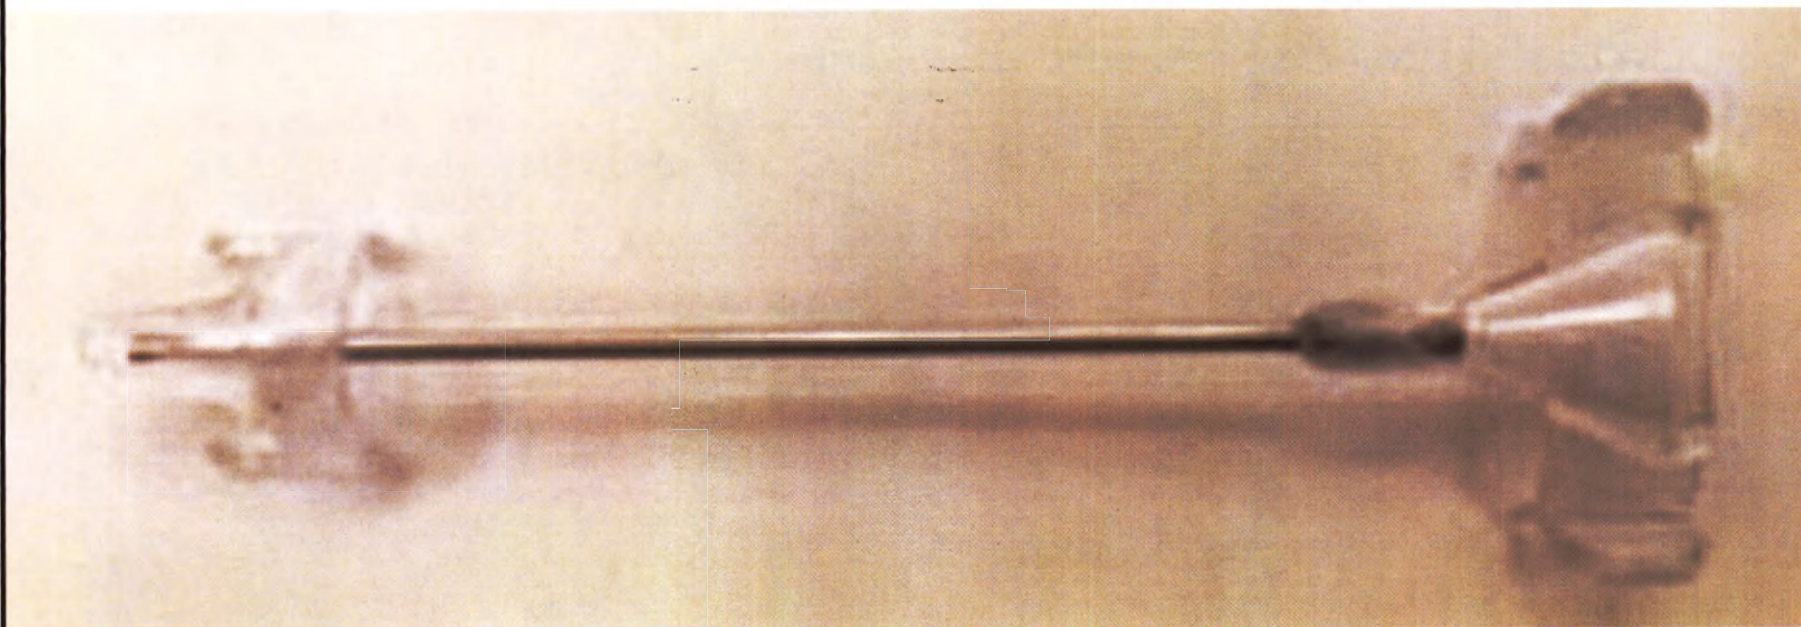


Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R3, R4)

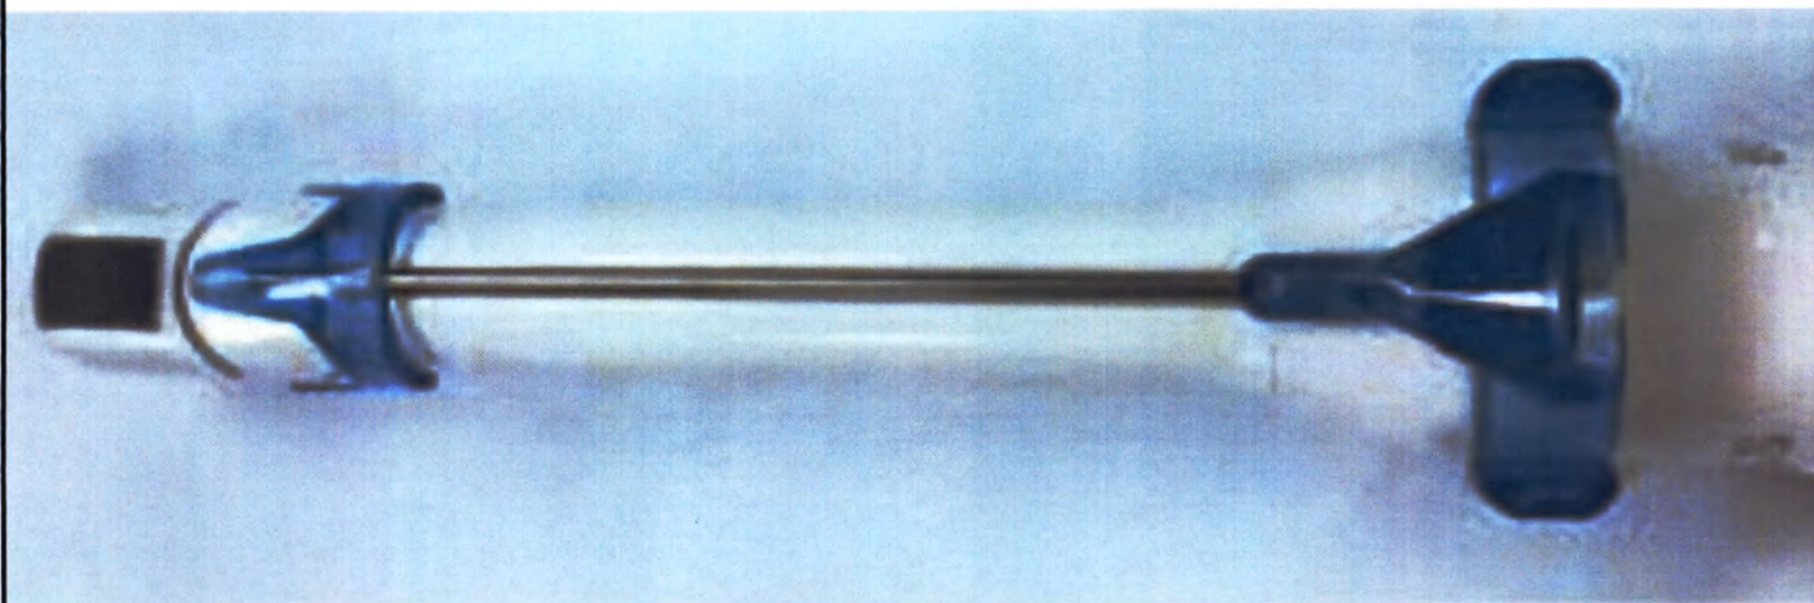


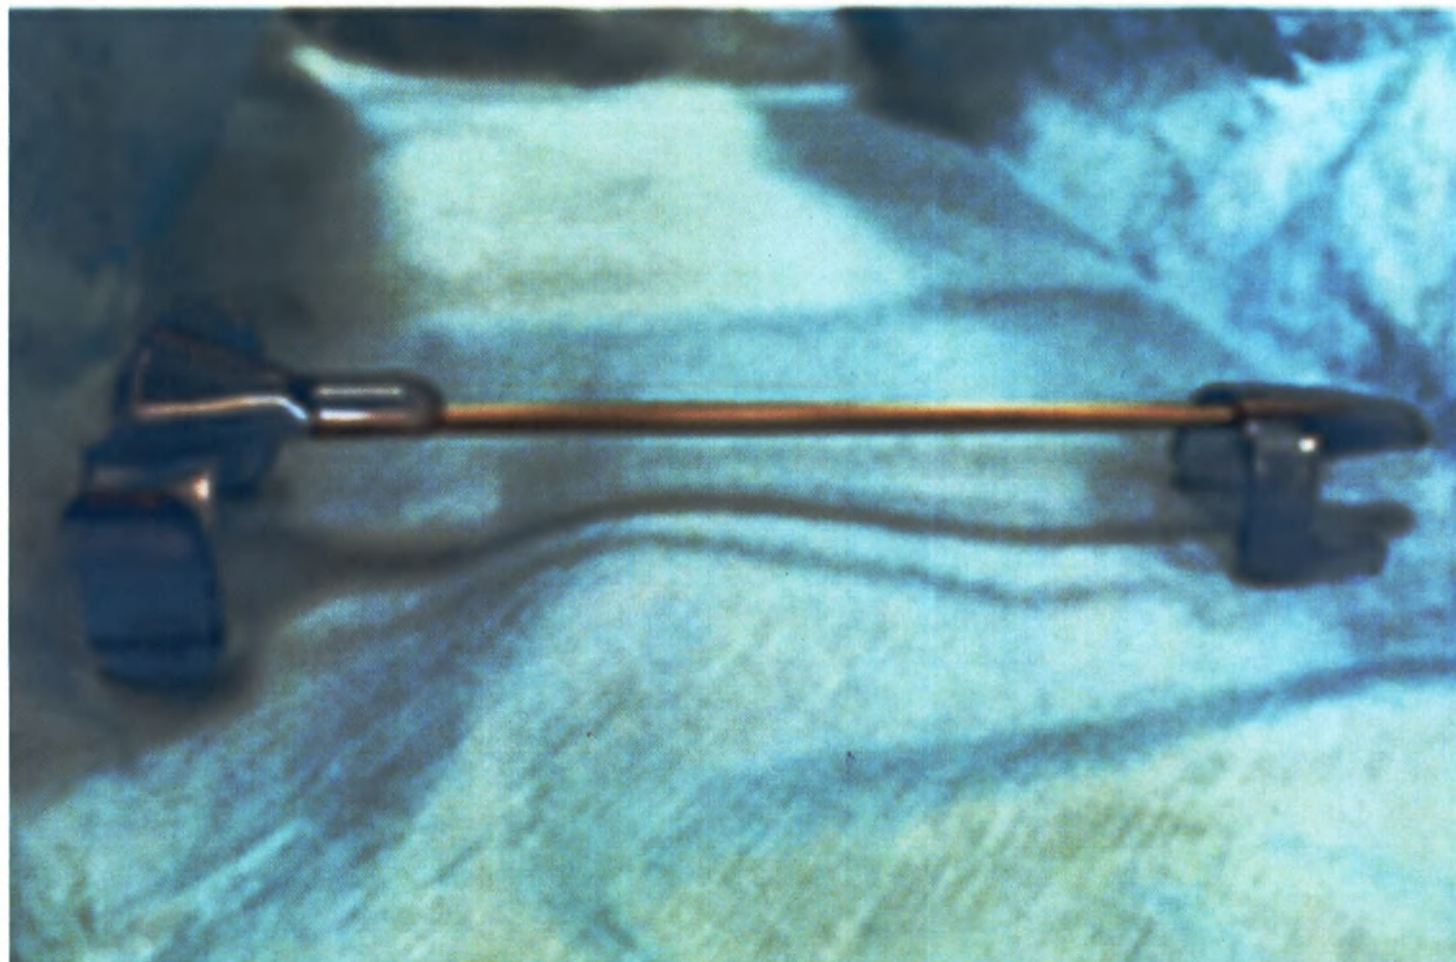

Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R2, R3, R4)

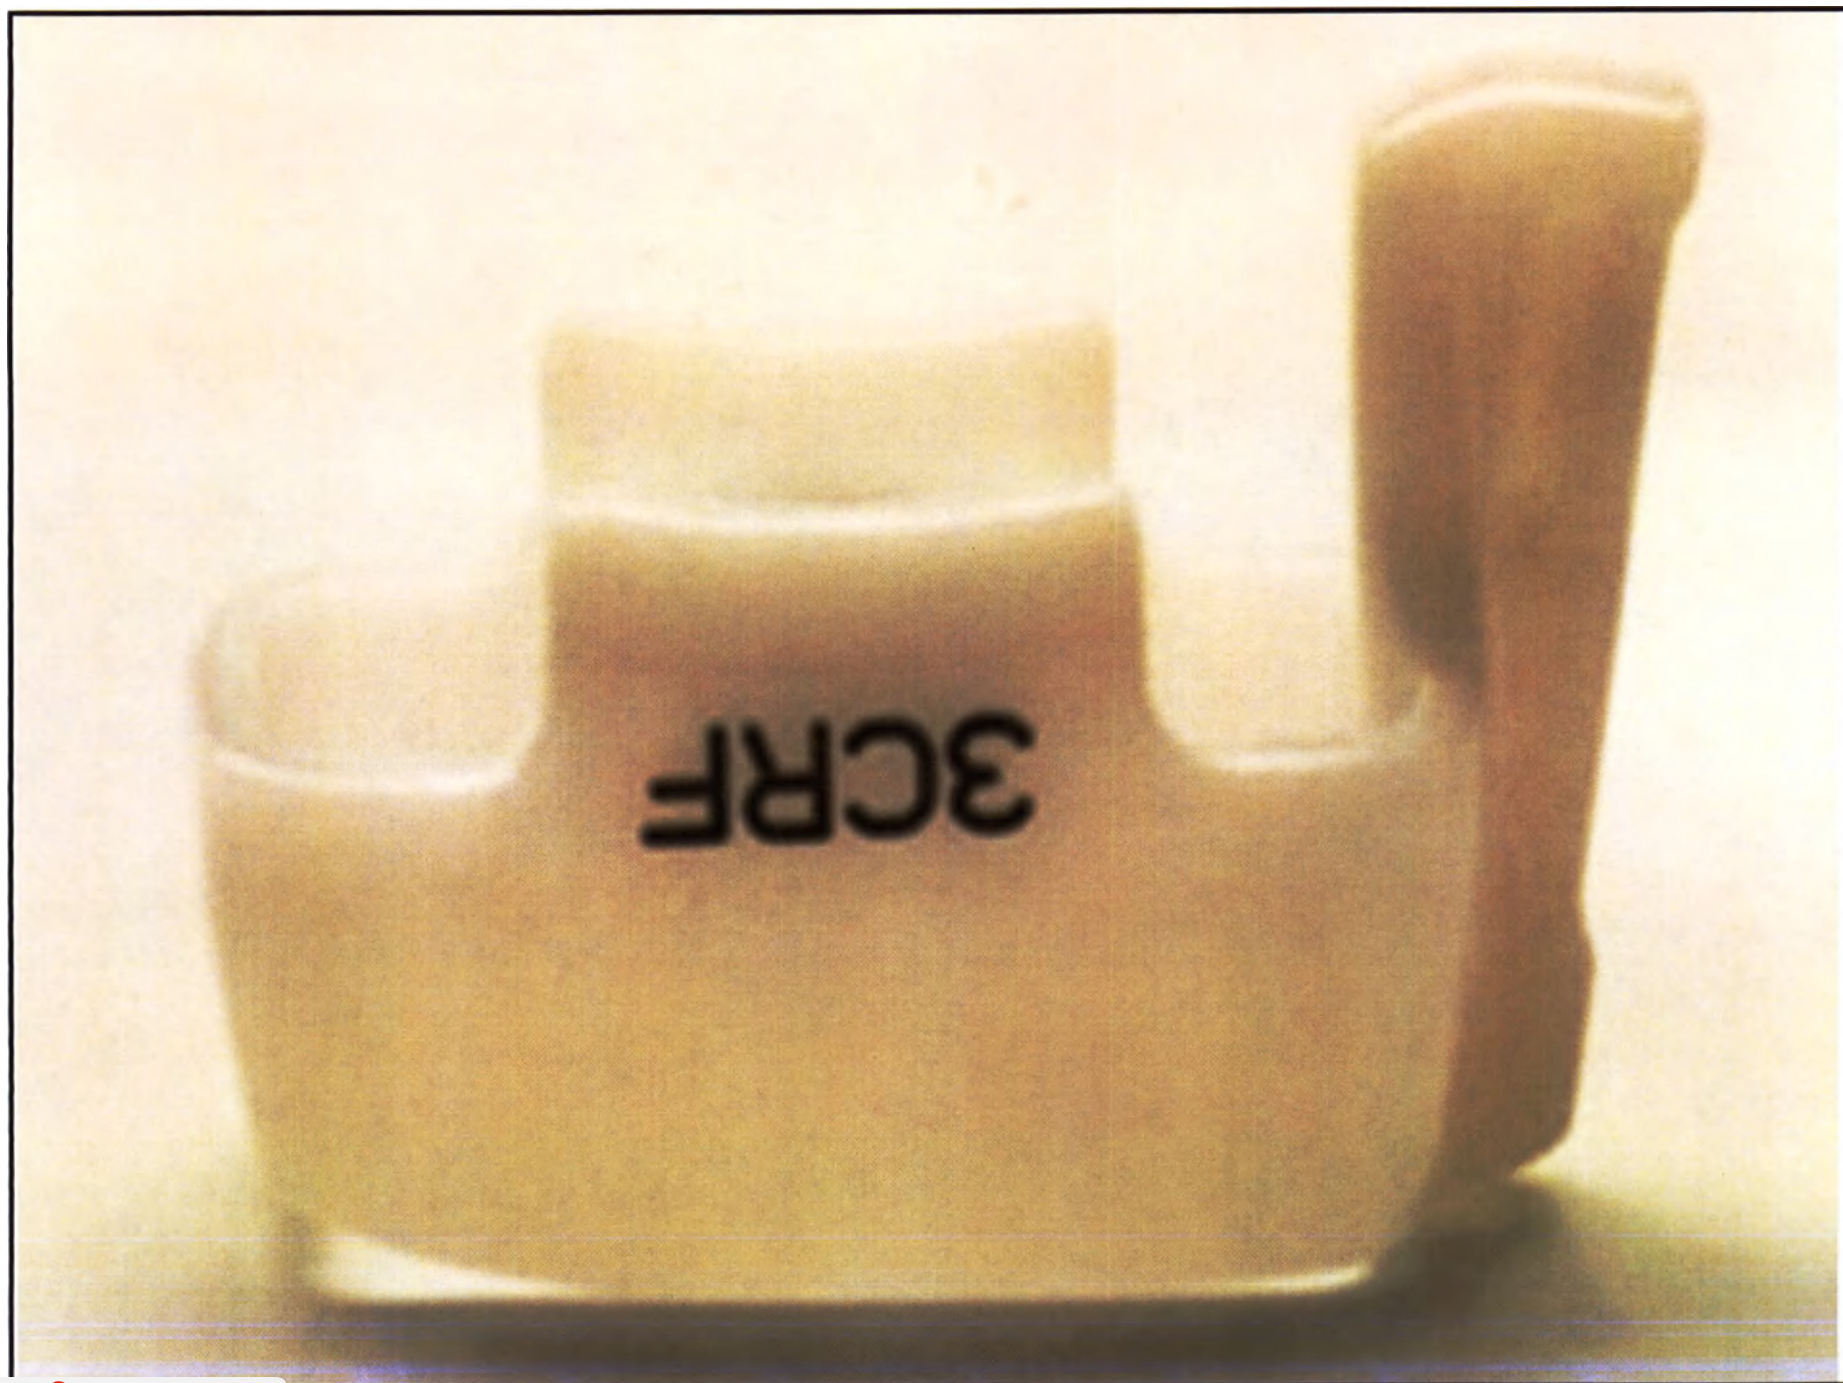


Адаптеры для проведения биопсий для микроконвексных датчиков (не более 15шт.). (Версии: R2, R3, R4)

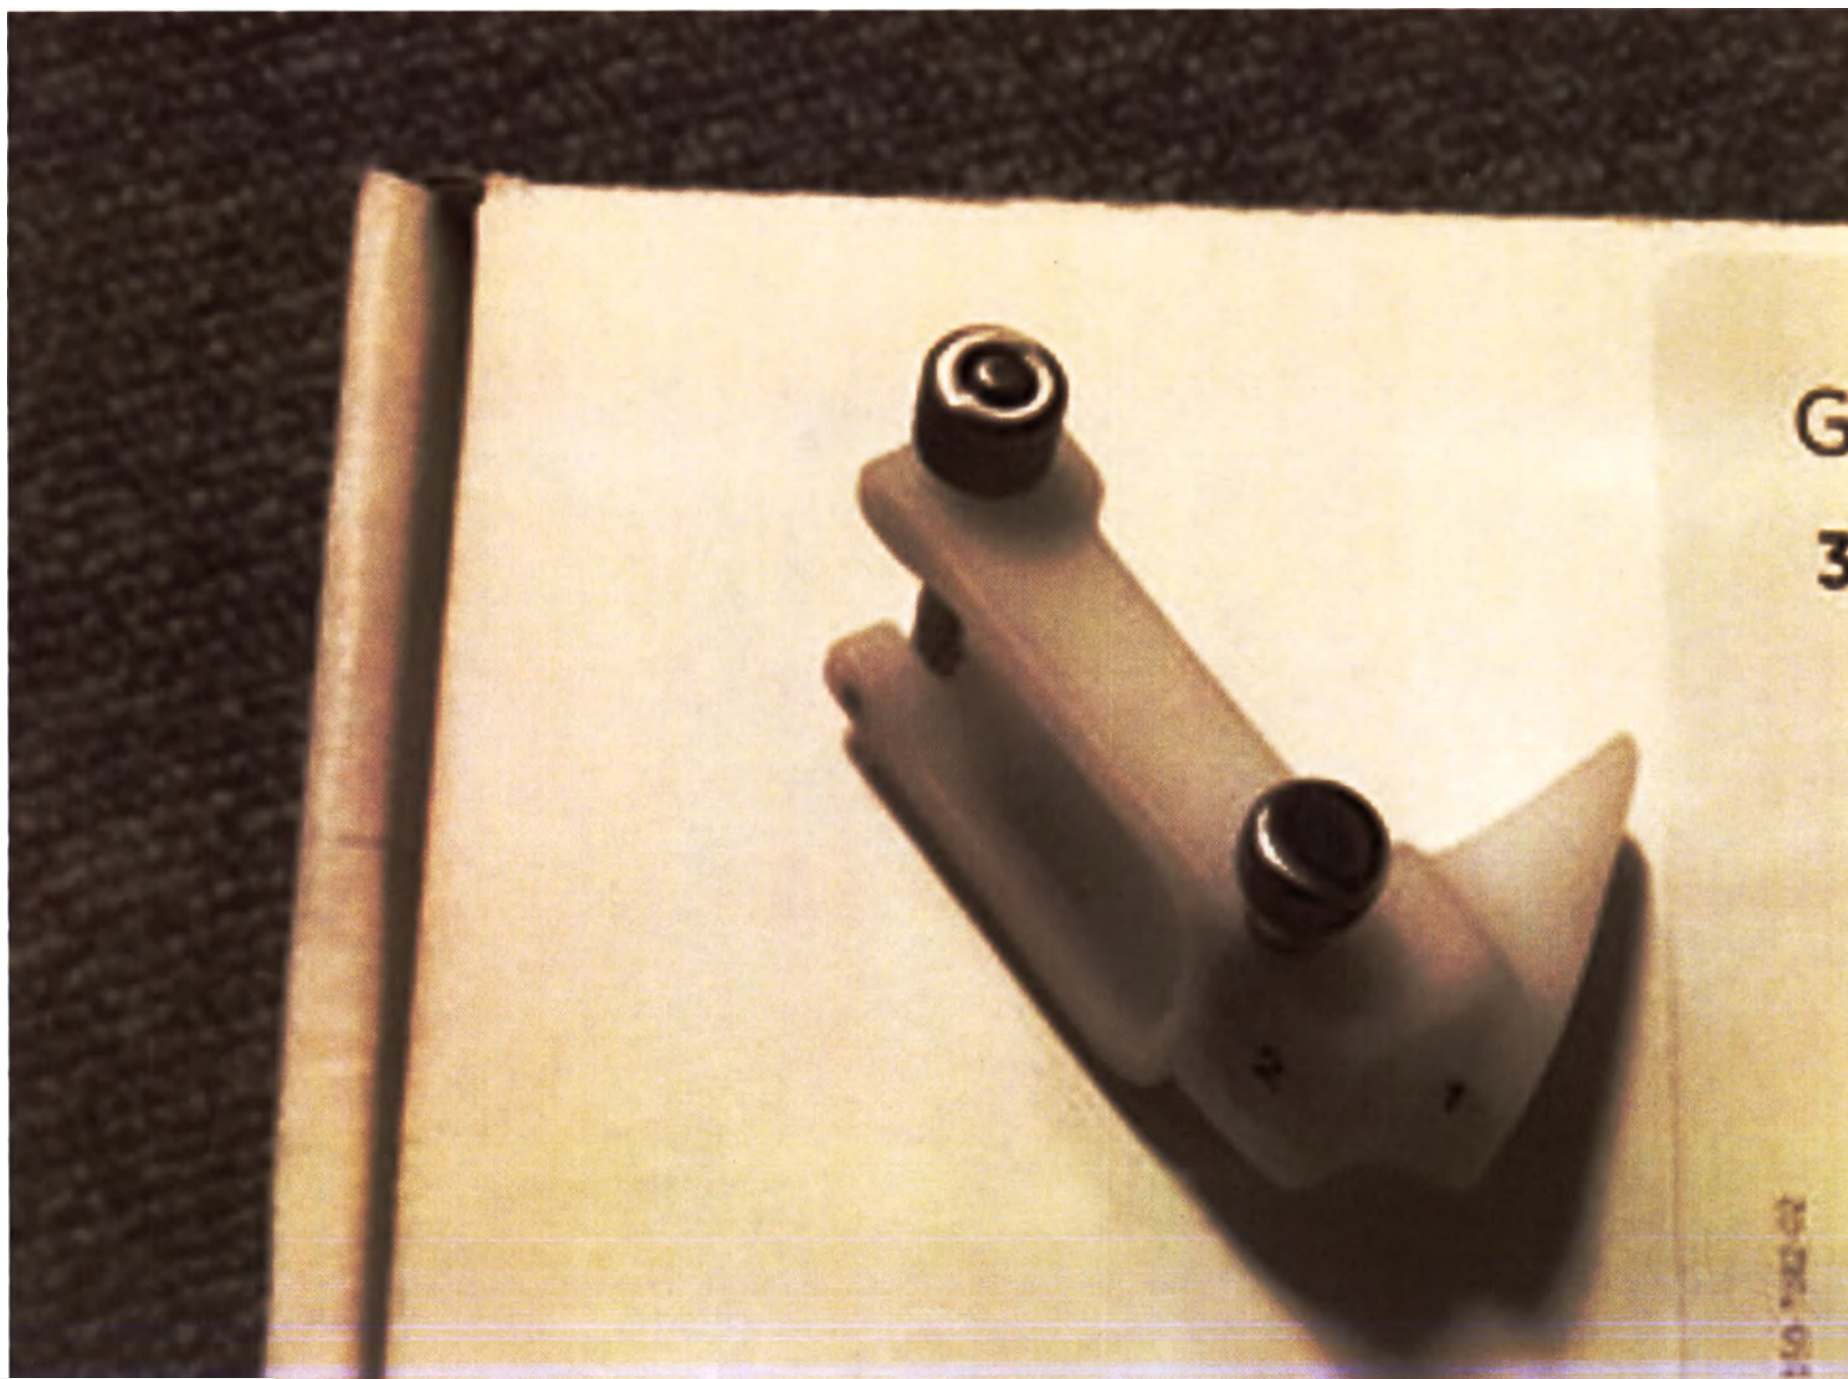


Адаптеры для проведения объемной навигации для микроконвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для микроконвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

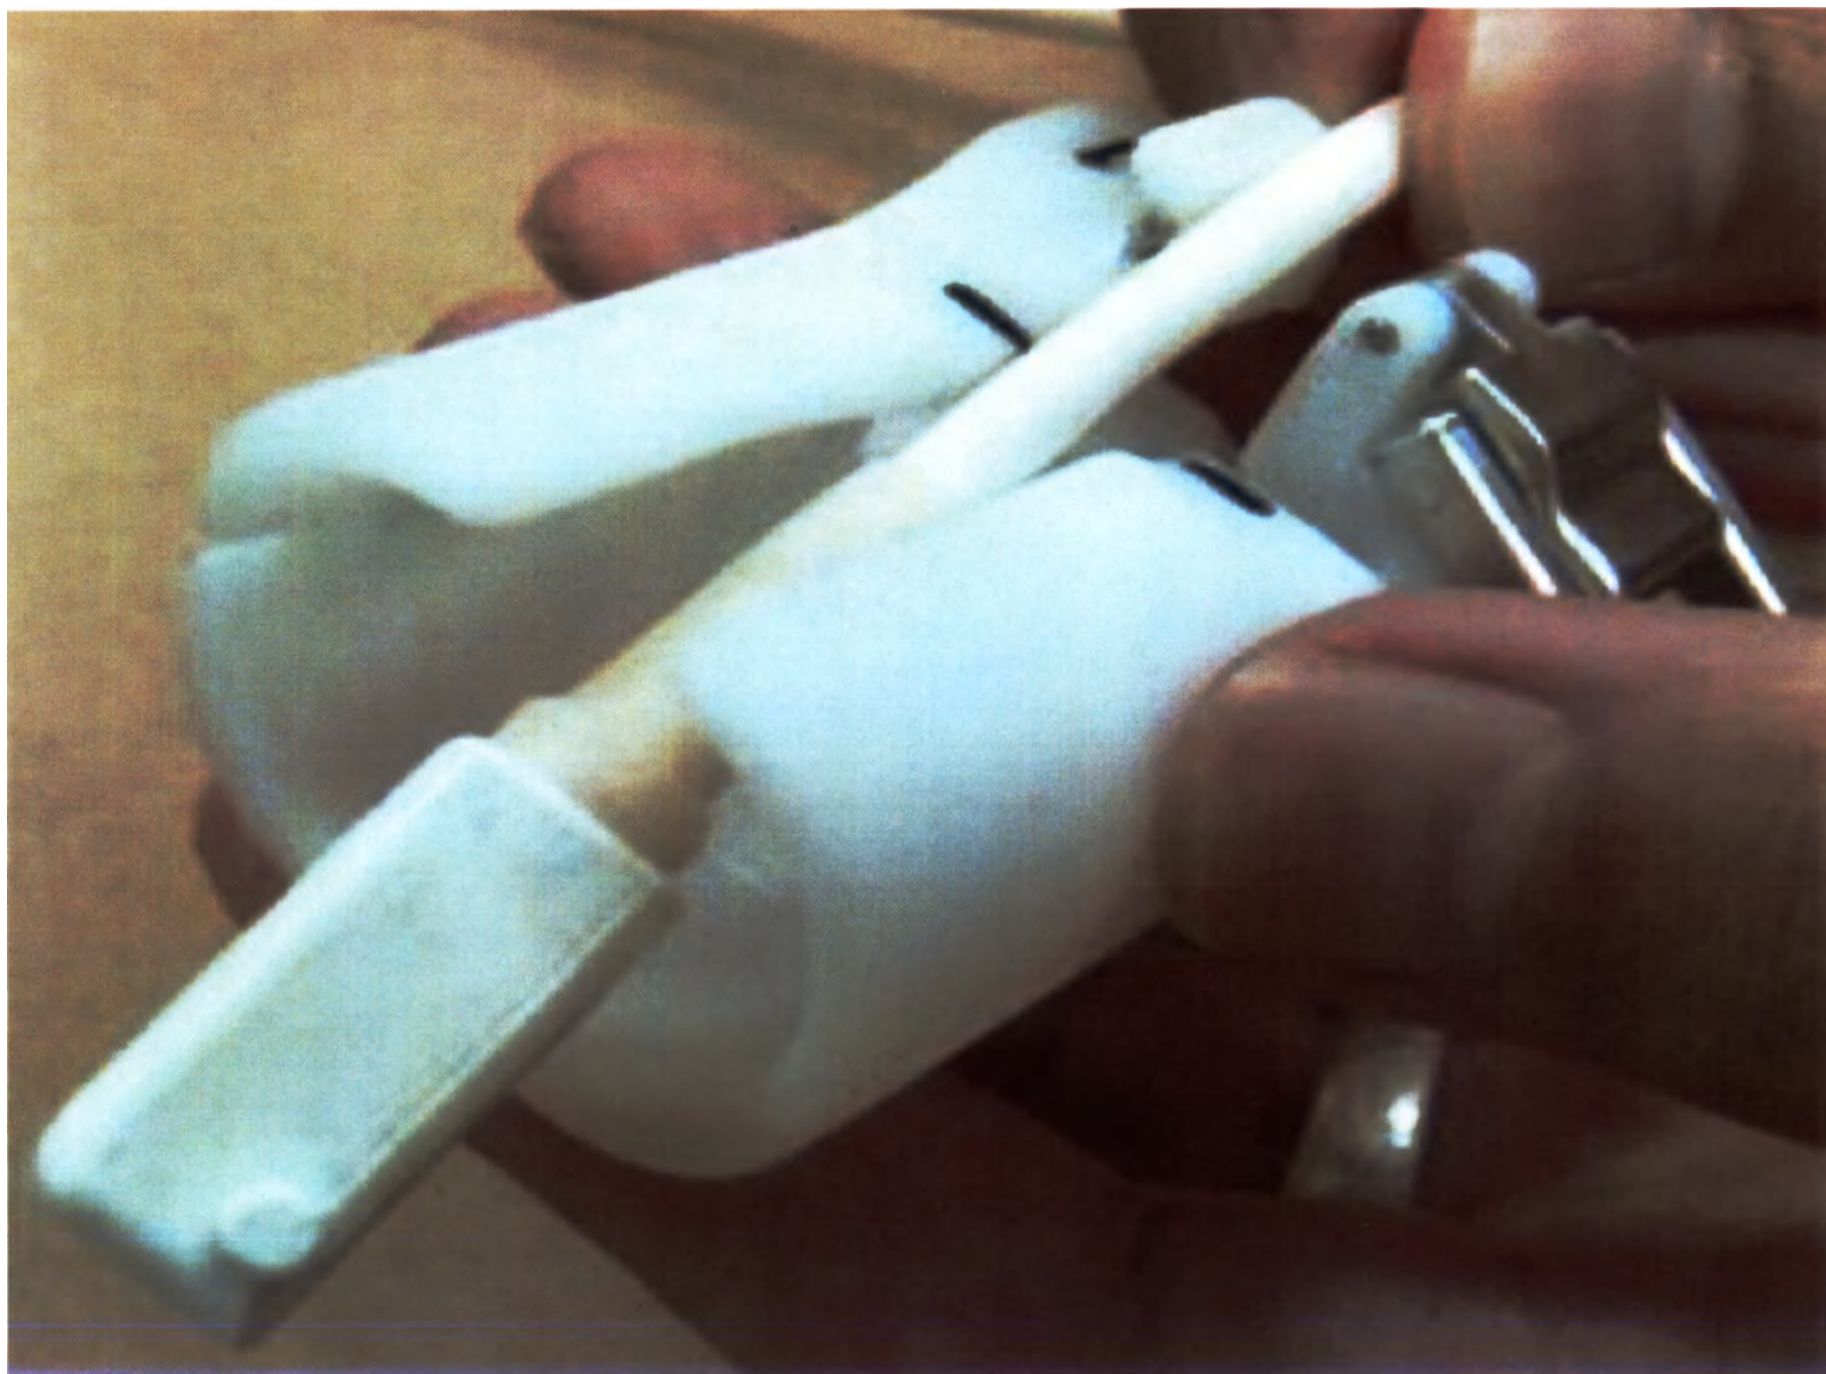


Адаптеры для проведения объемной навигации для микроконвексных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

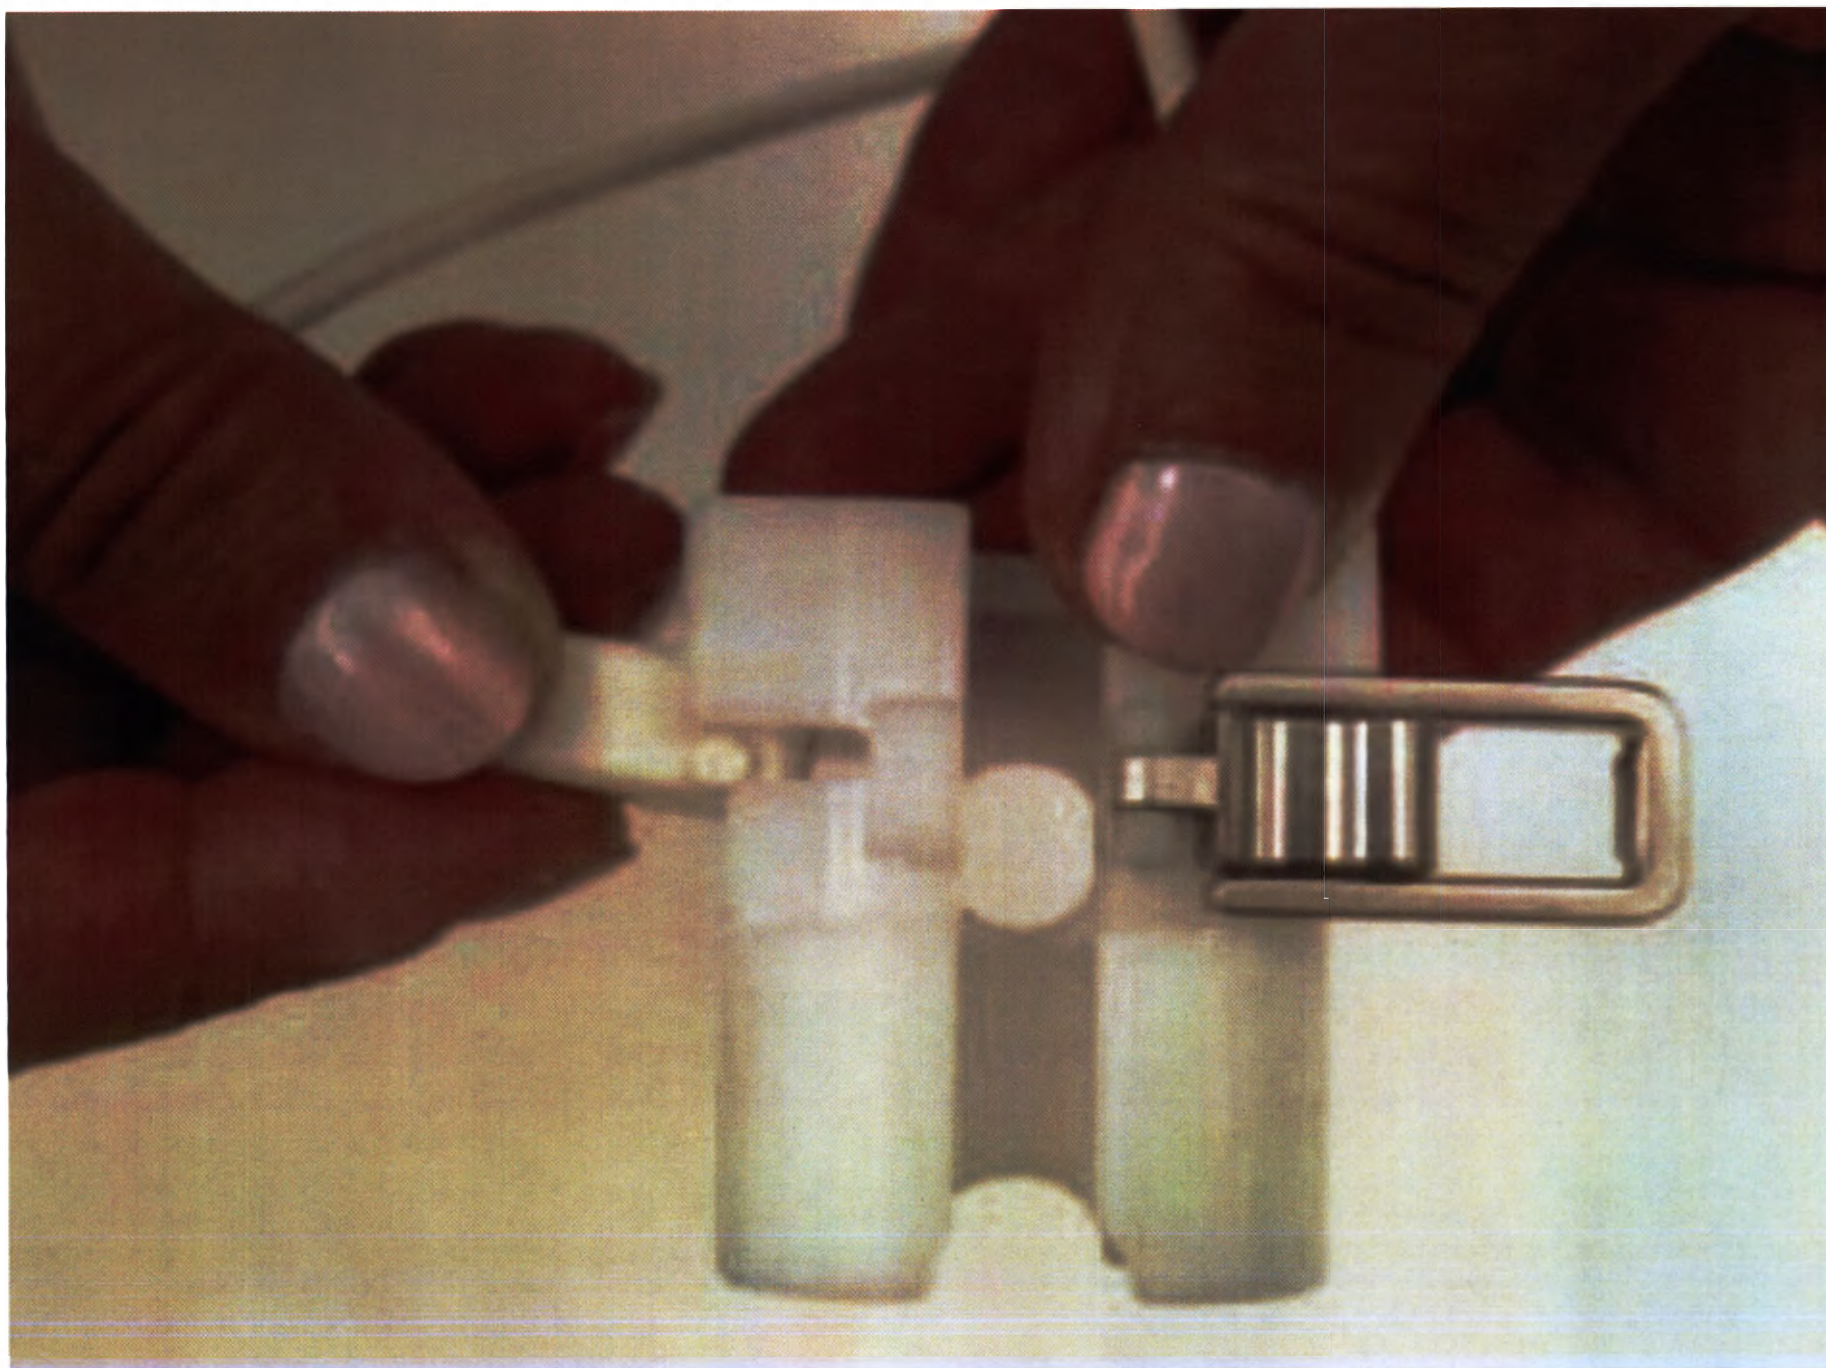

Датчики матричные серии М (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики матричные серии М (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

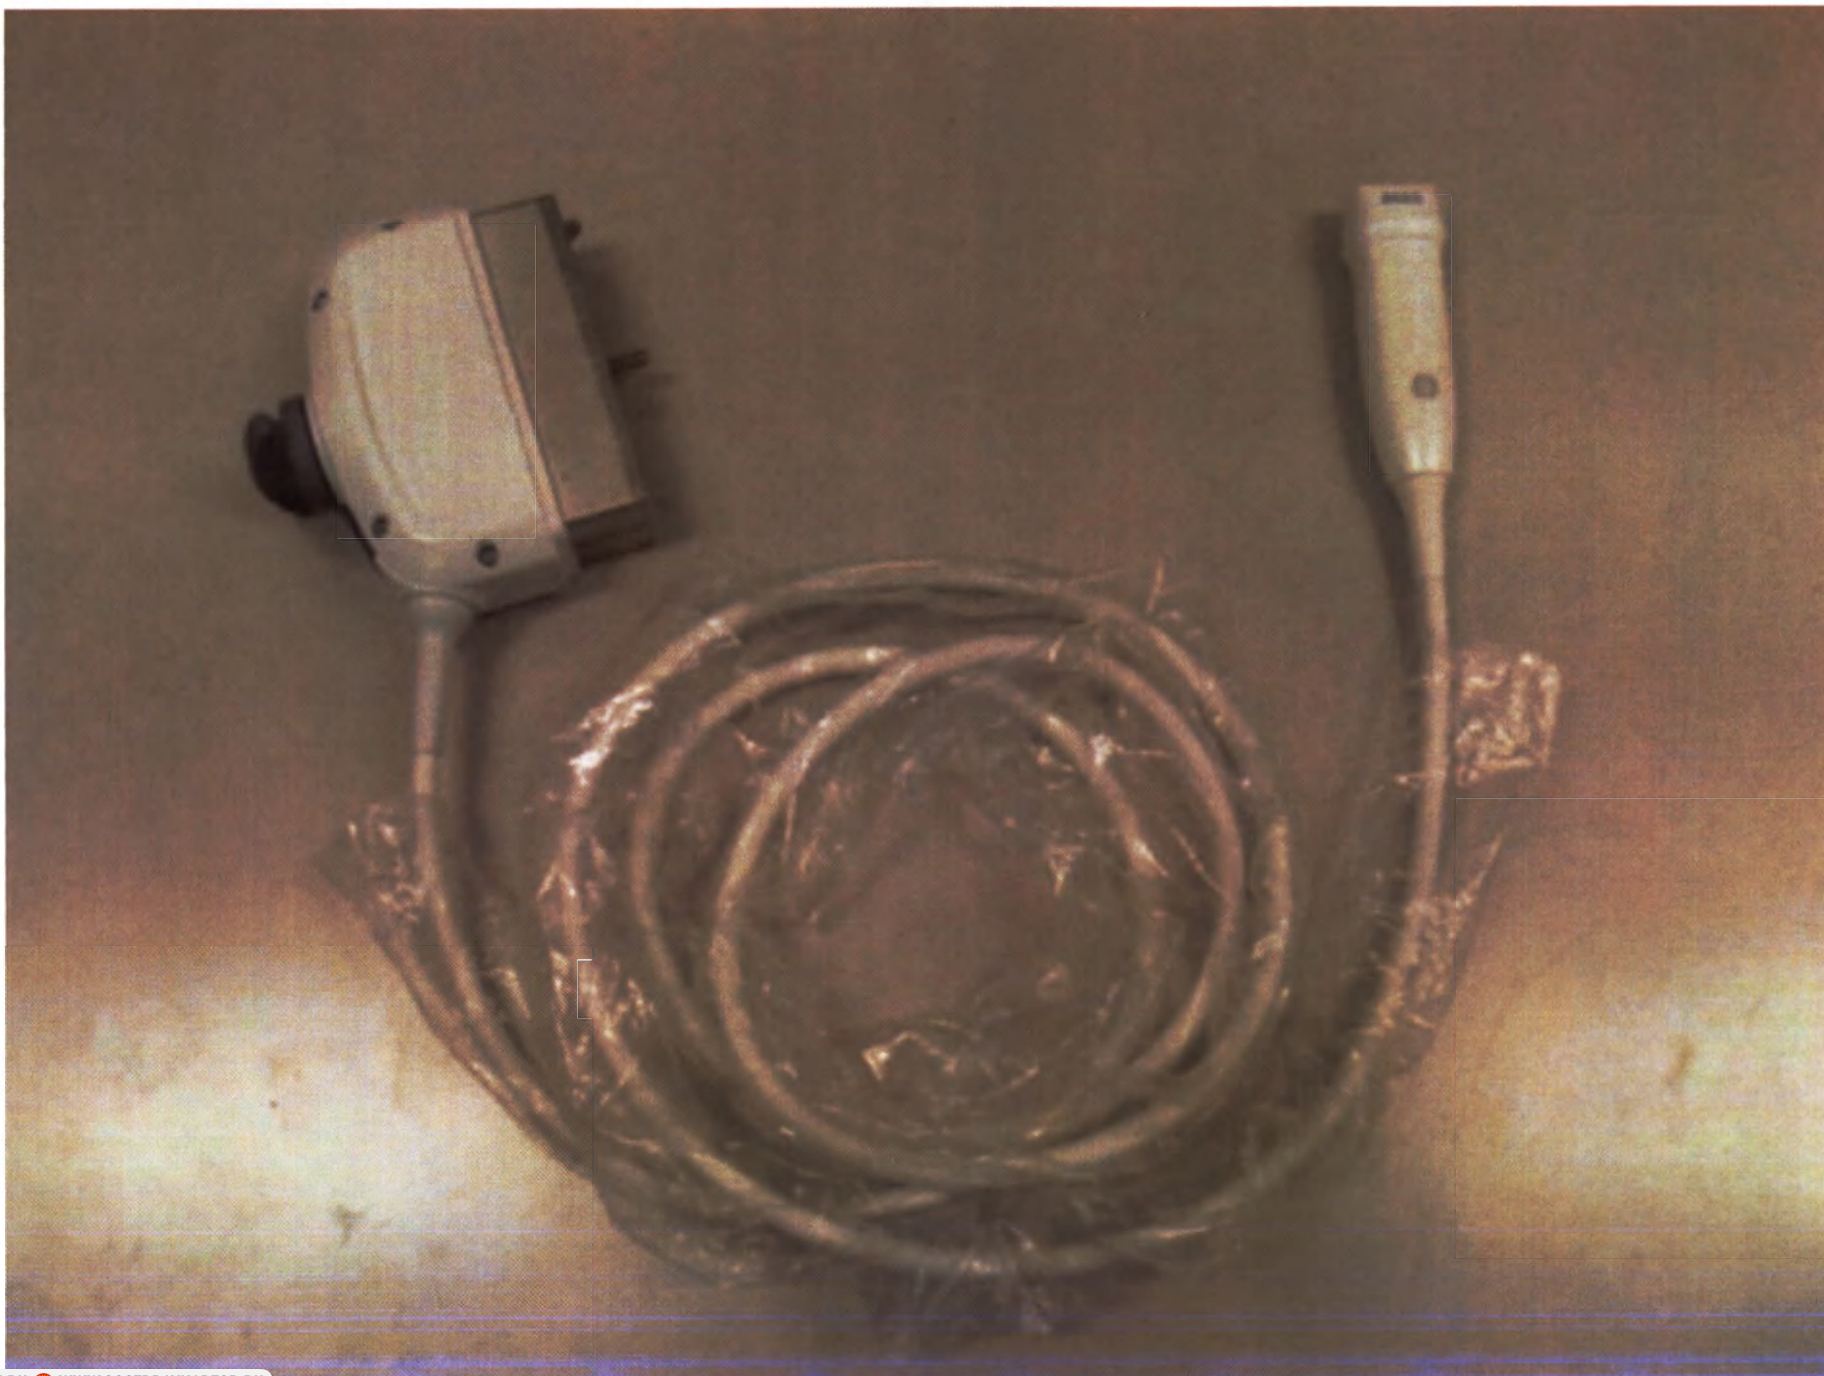


Датчики матричные серии М (не более 5 шт.). (Версии: R4)



Адаптеры для проведения биопсий для матричных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения объемной навигации для матричных датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

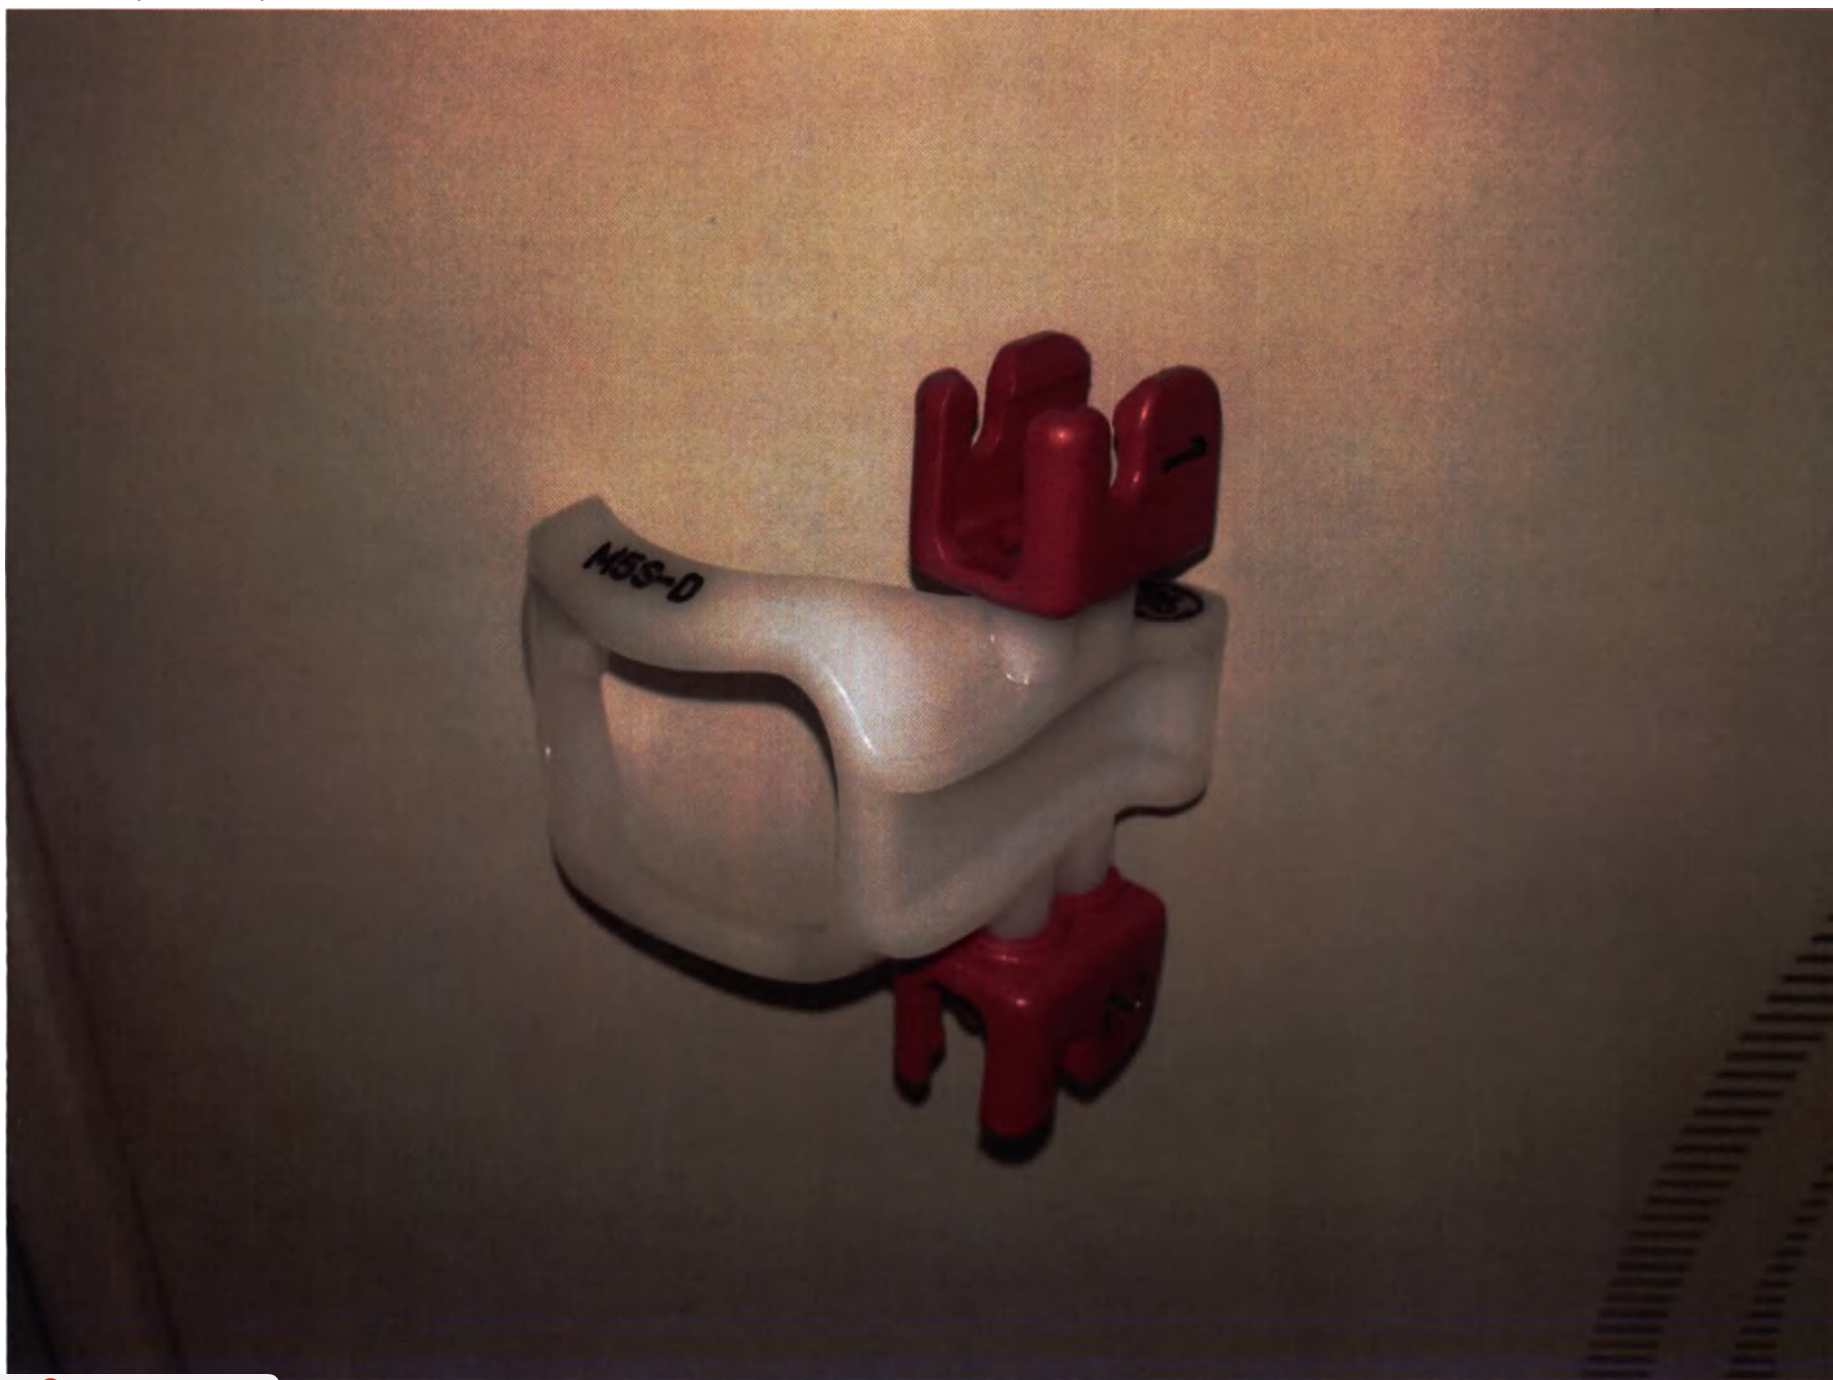

Датчики карандашные доплеровские серии D (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)




Датчики карандашные доплеровские серии D (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Датчики карандашные доплеровские серии D (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Датчики конвексные серии RAB (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

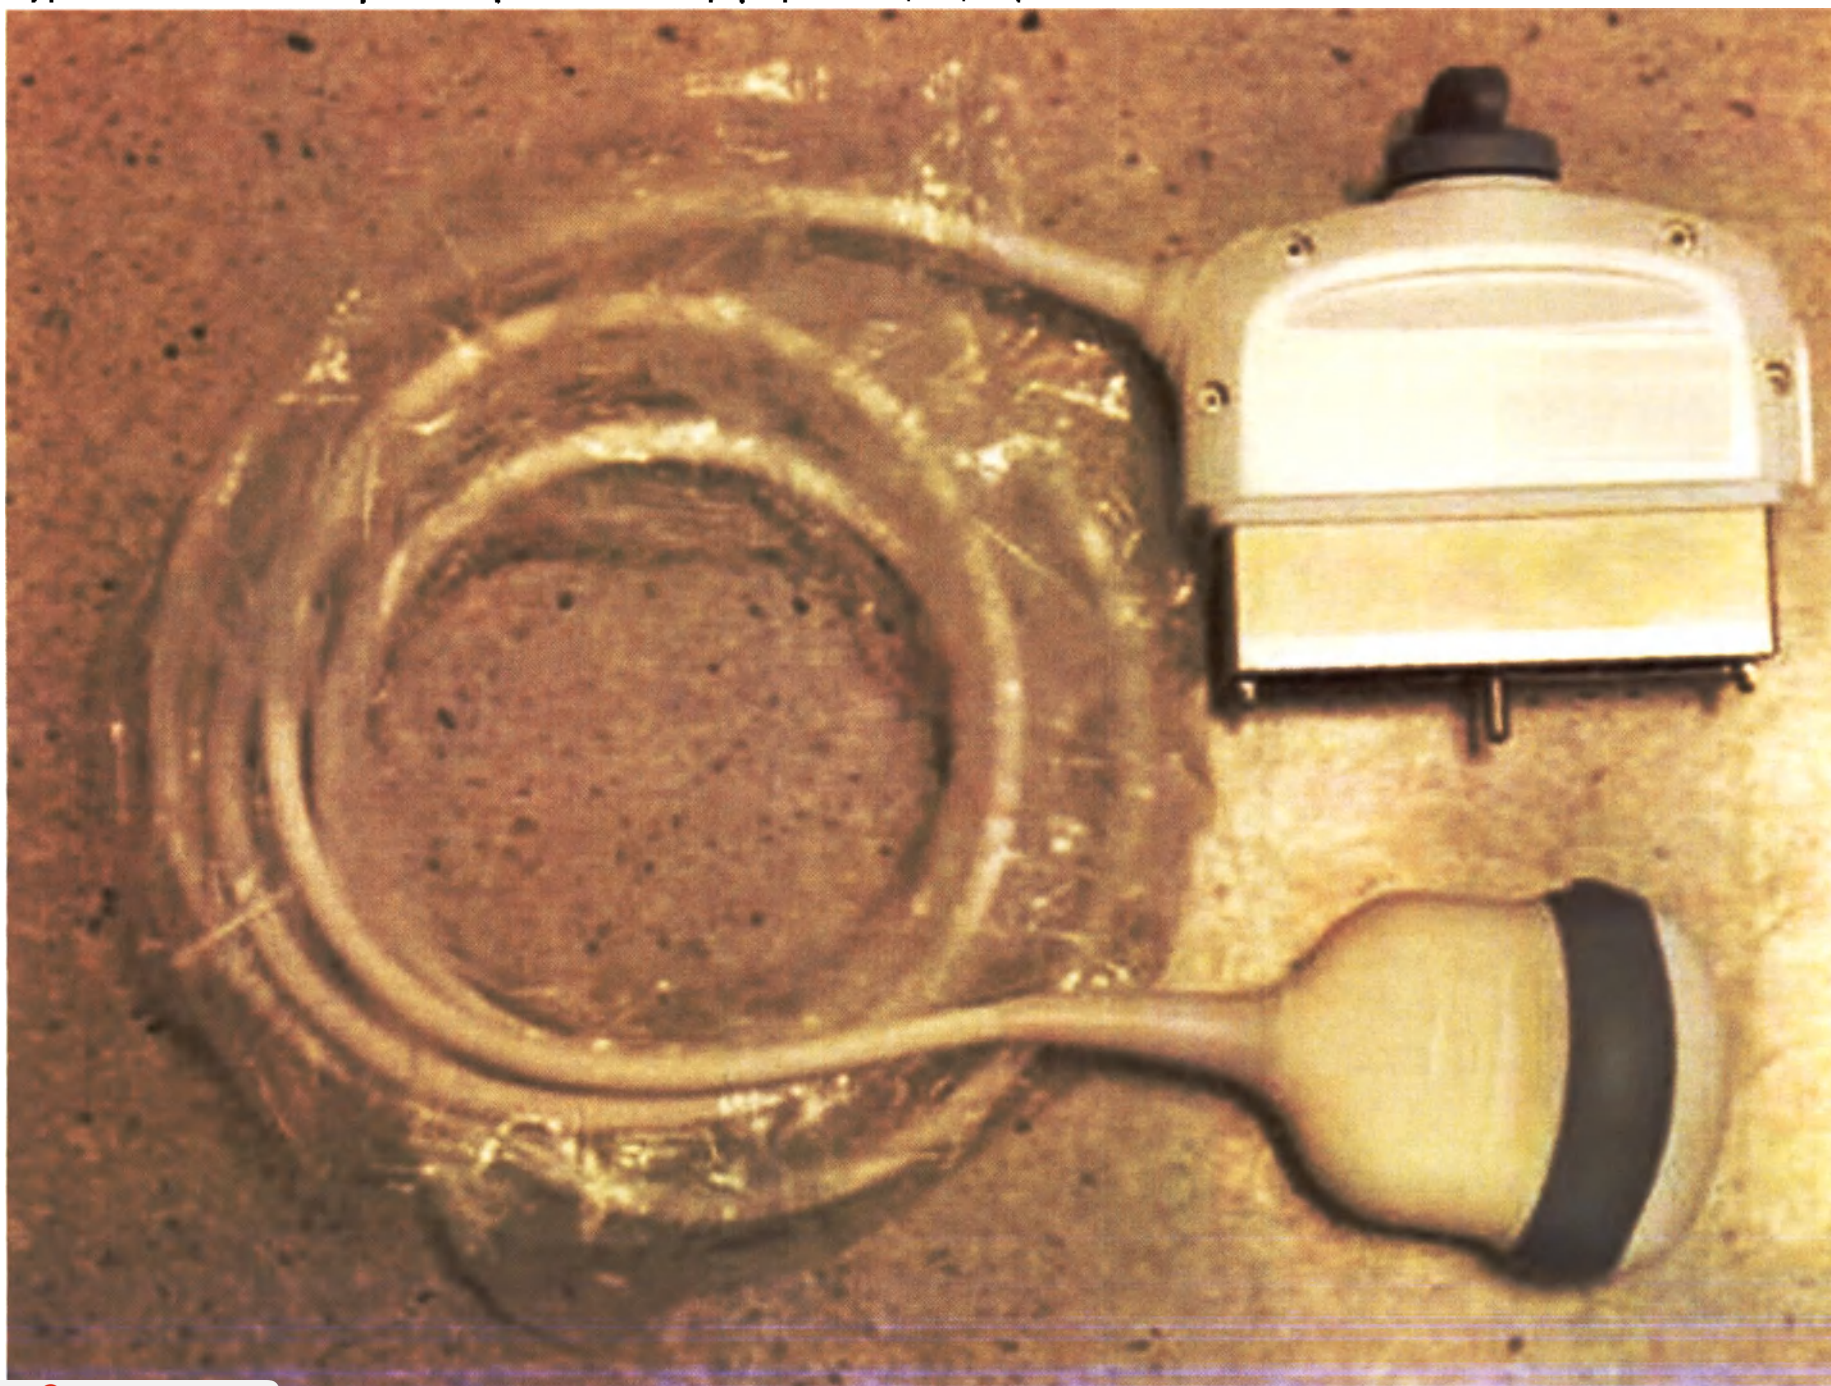


Адаптеры для проведения биопсий для конвексных датчиков серии RAB (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

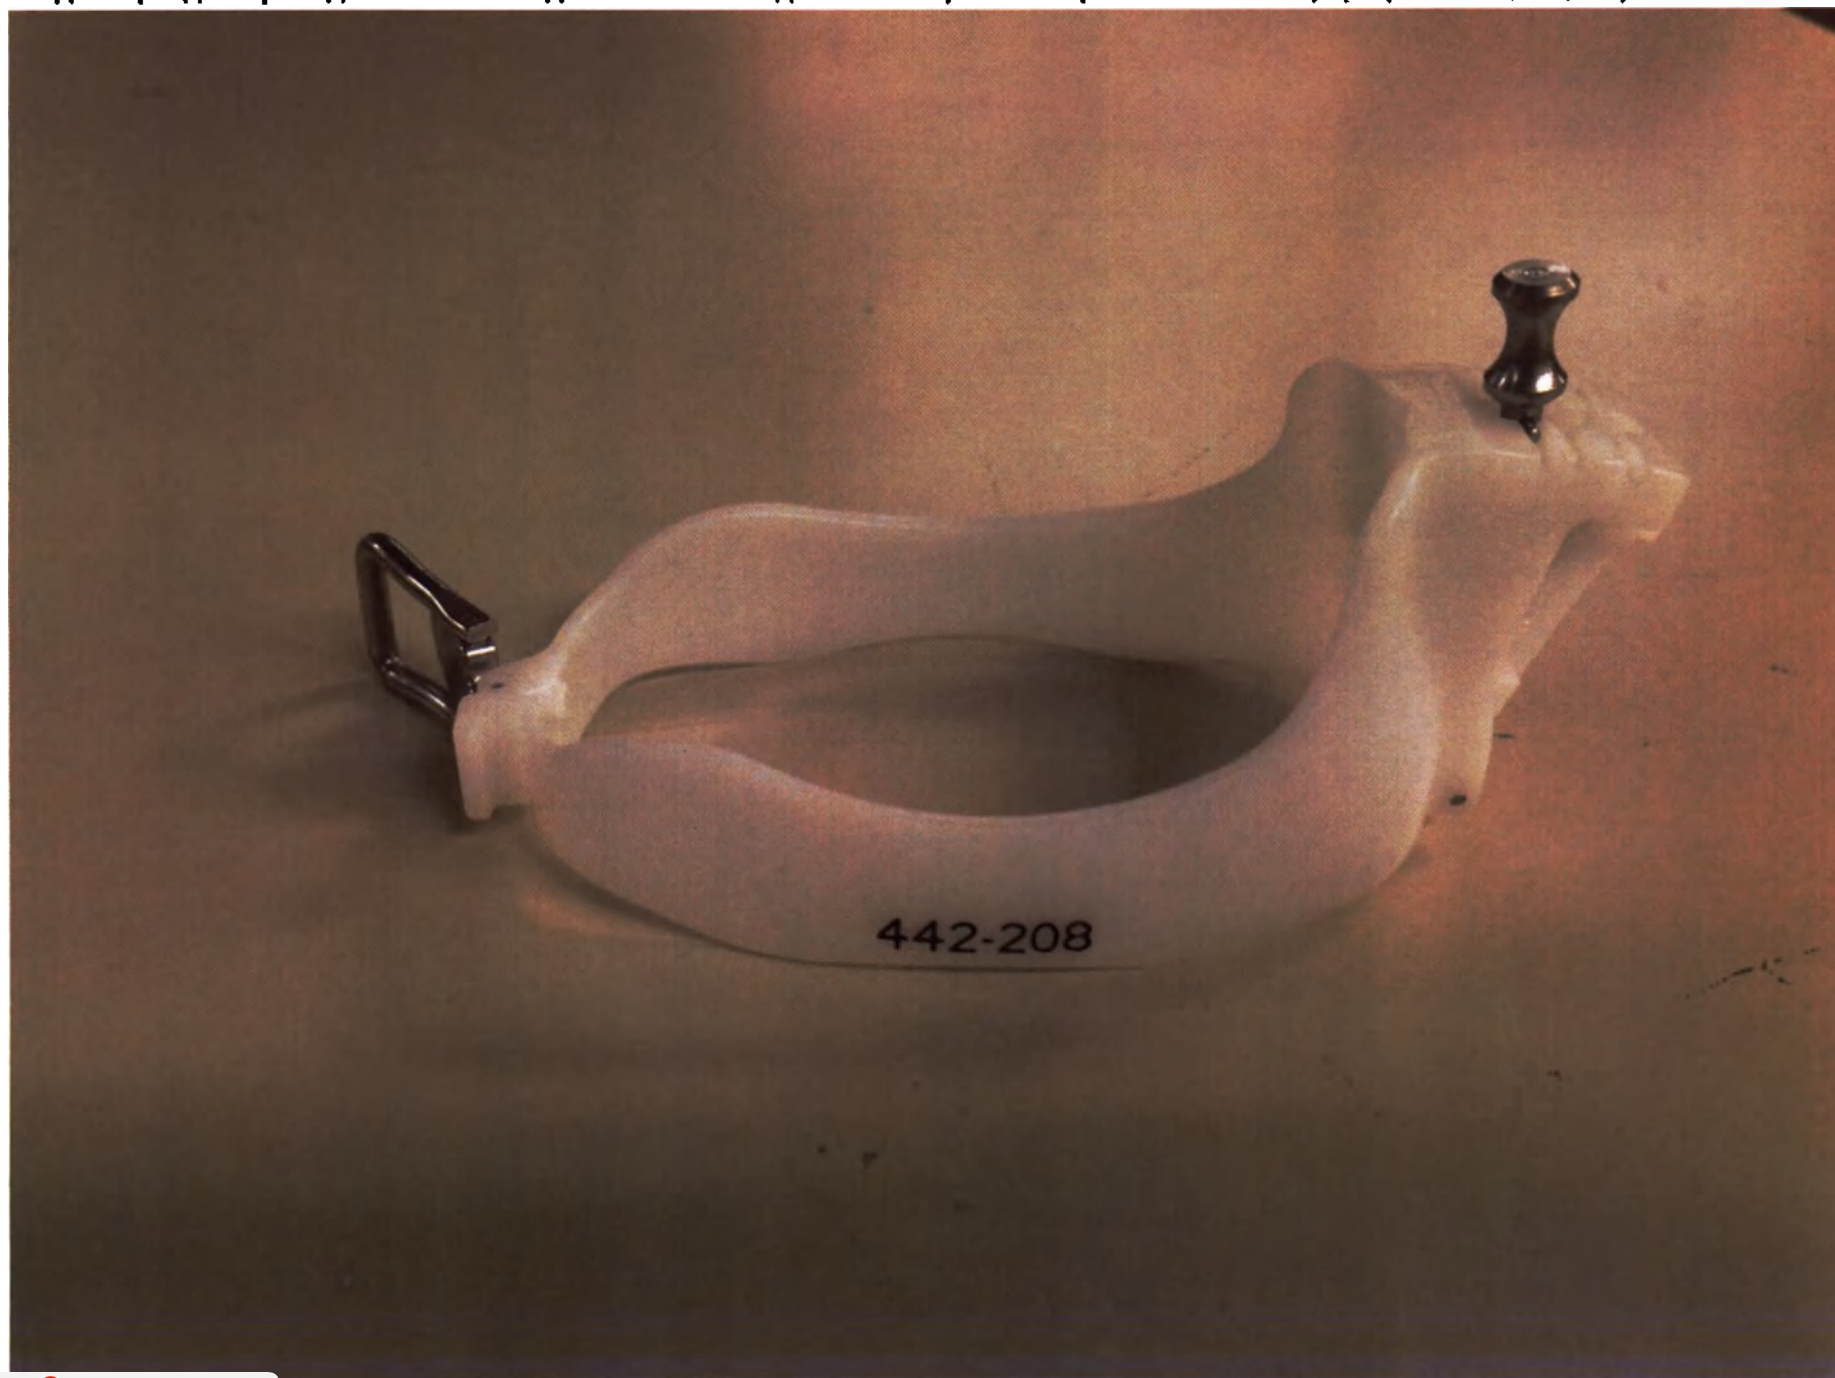

Датчики линейные серии RSP (не более 5 шт.). (Версии: R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для линейных датчиков серии RSP (не более 10 шт.). (Версии: R3, R4)

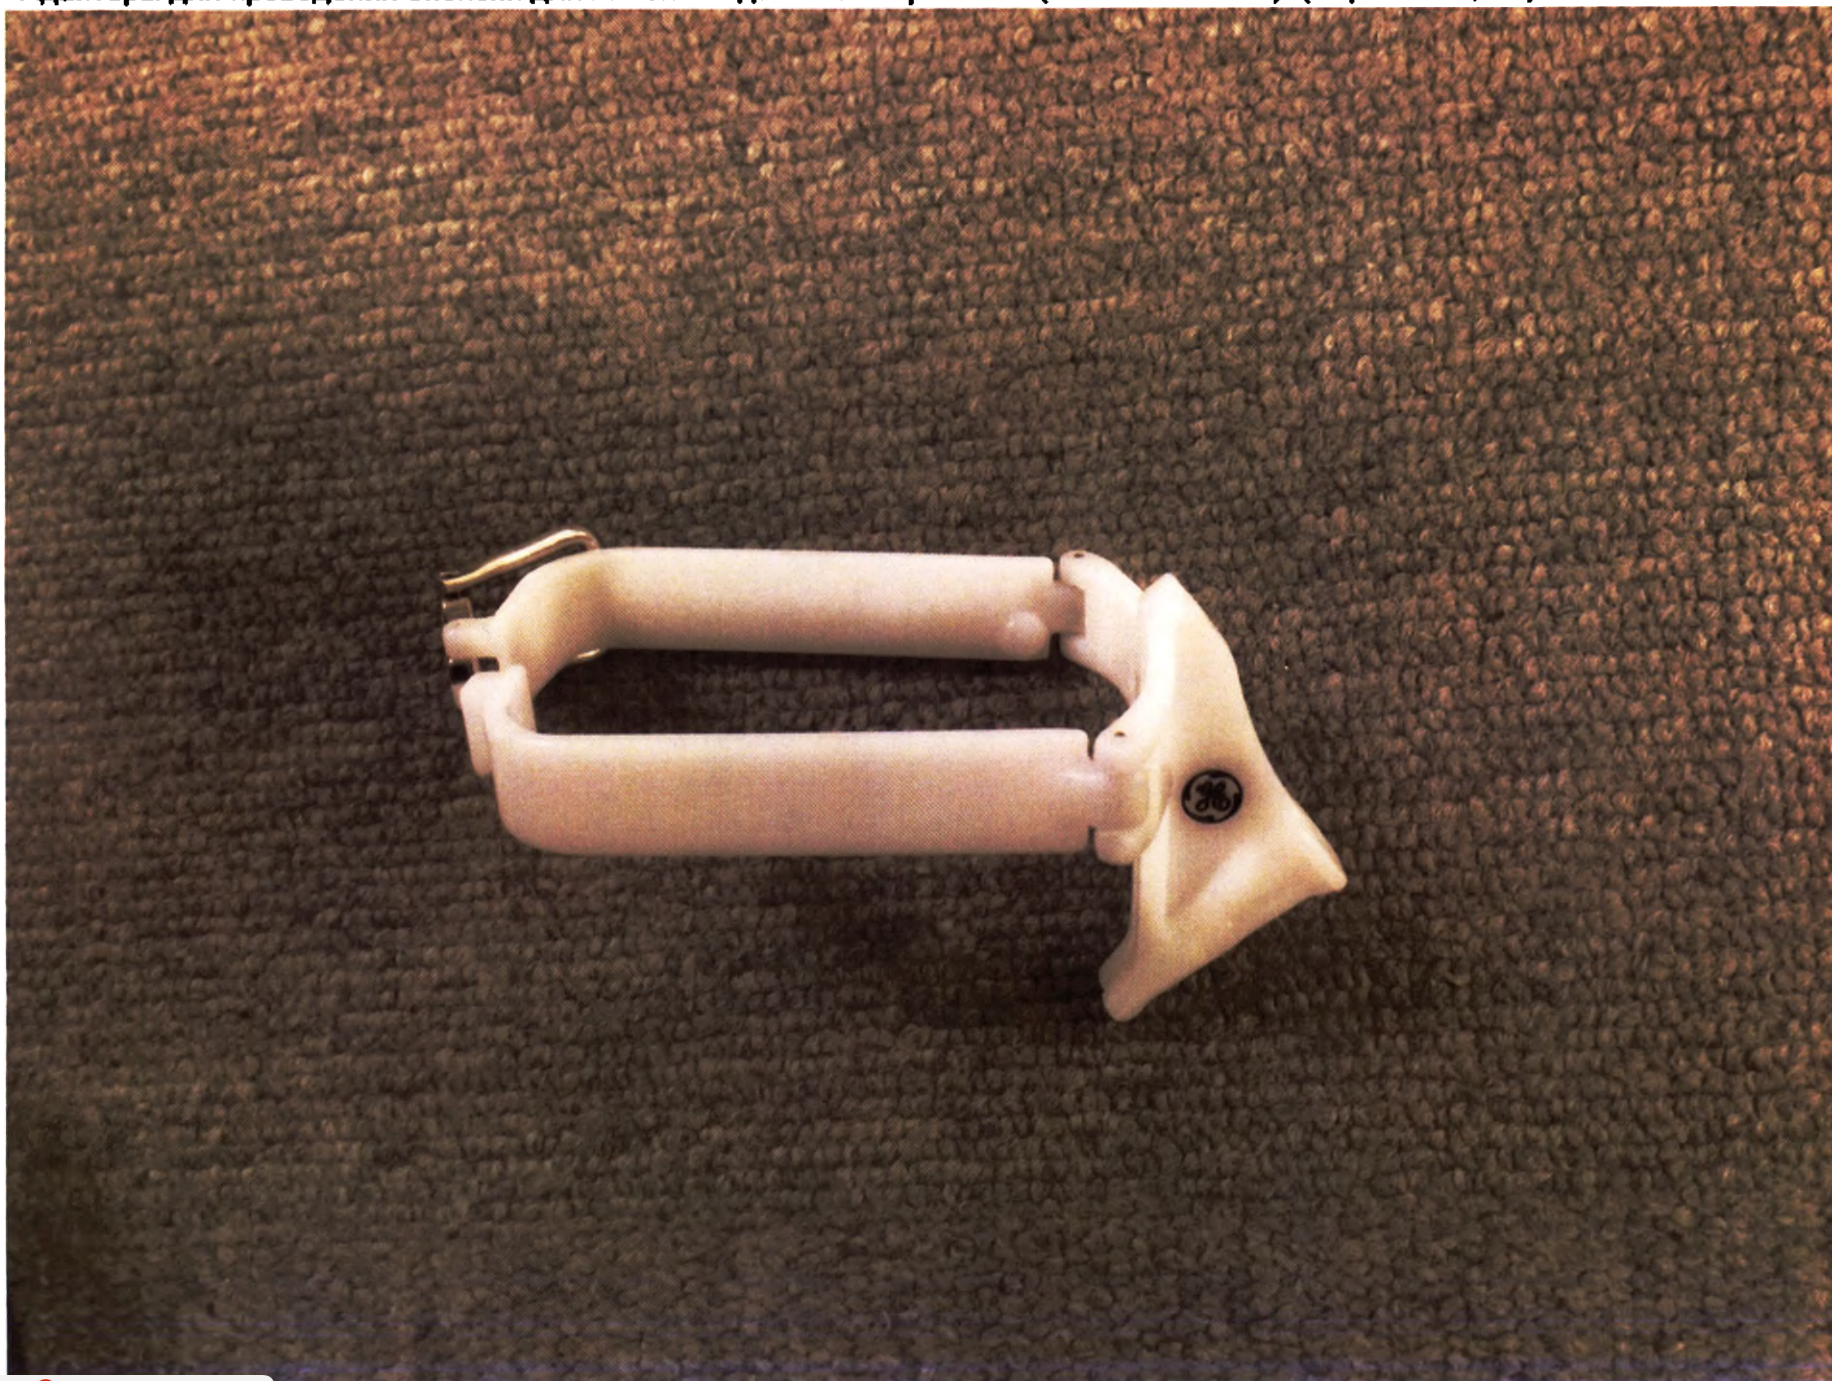

Датчики внутрисосудистые серии RIC (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Адаптеры для проведения биопсий для внутрисполостных датчиков серии RIC (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Датчики чреспищеводные фазированные серии Т (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Устройства для очистки и хранения чреспищеводных датчиков TEE Cleaning and Storage System (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Держатели для чреспищеводных датчиков TEE Storage Rack (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

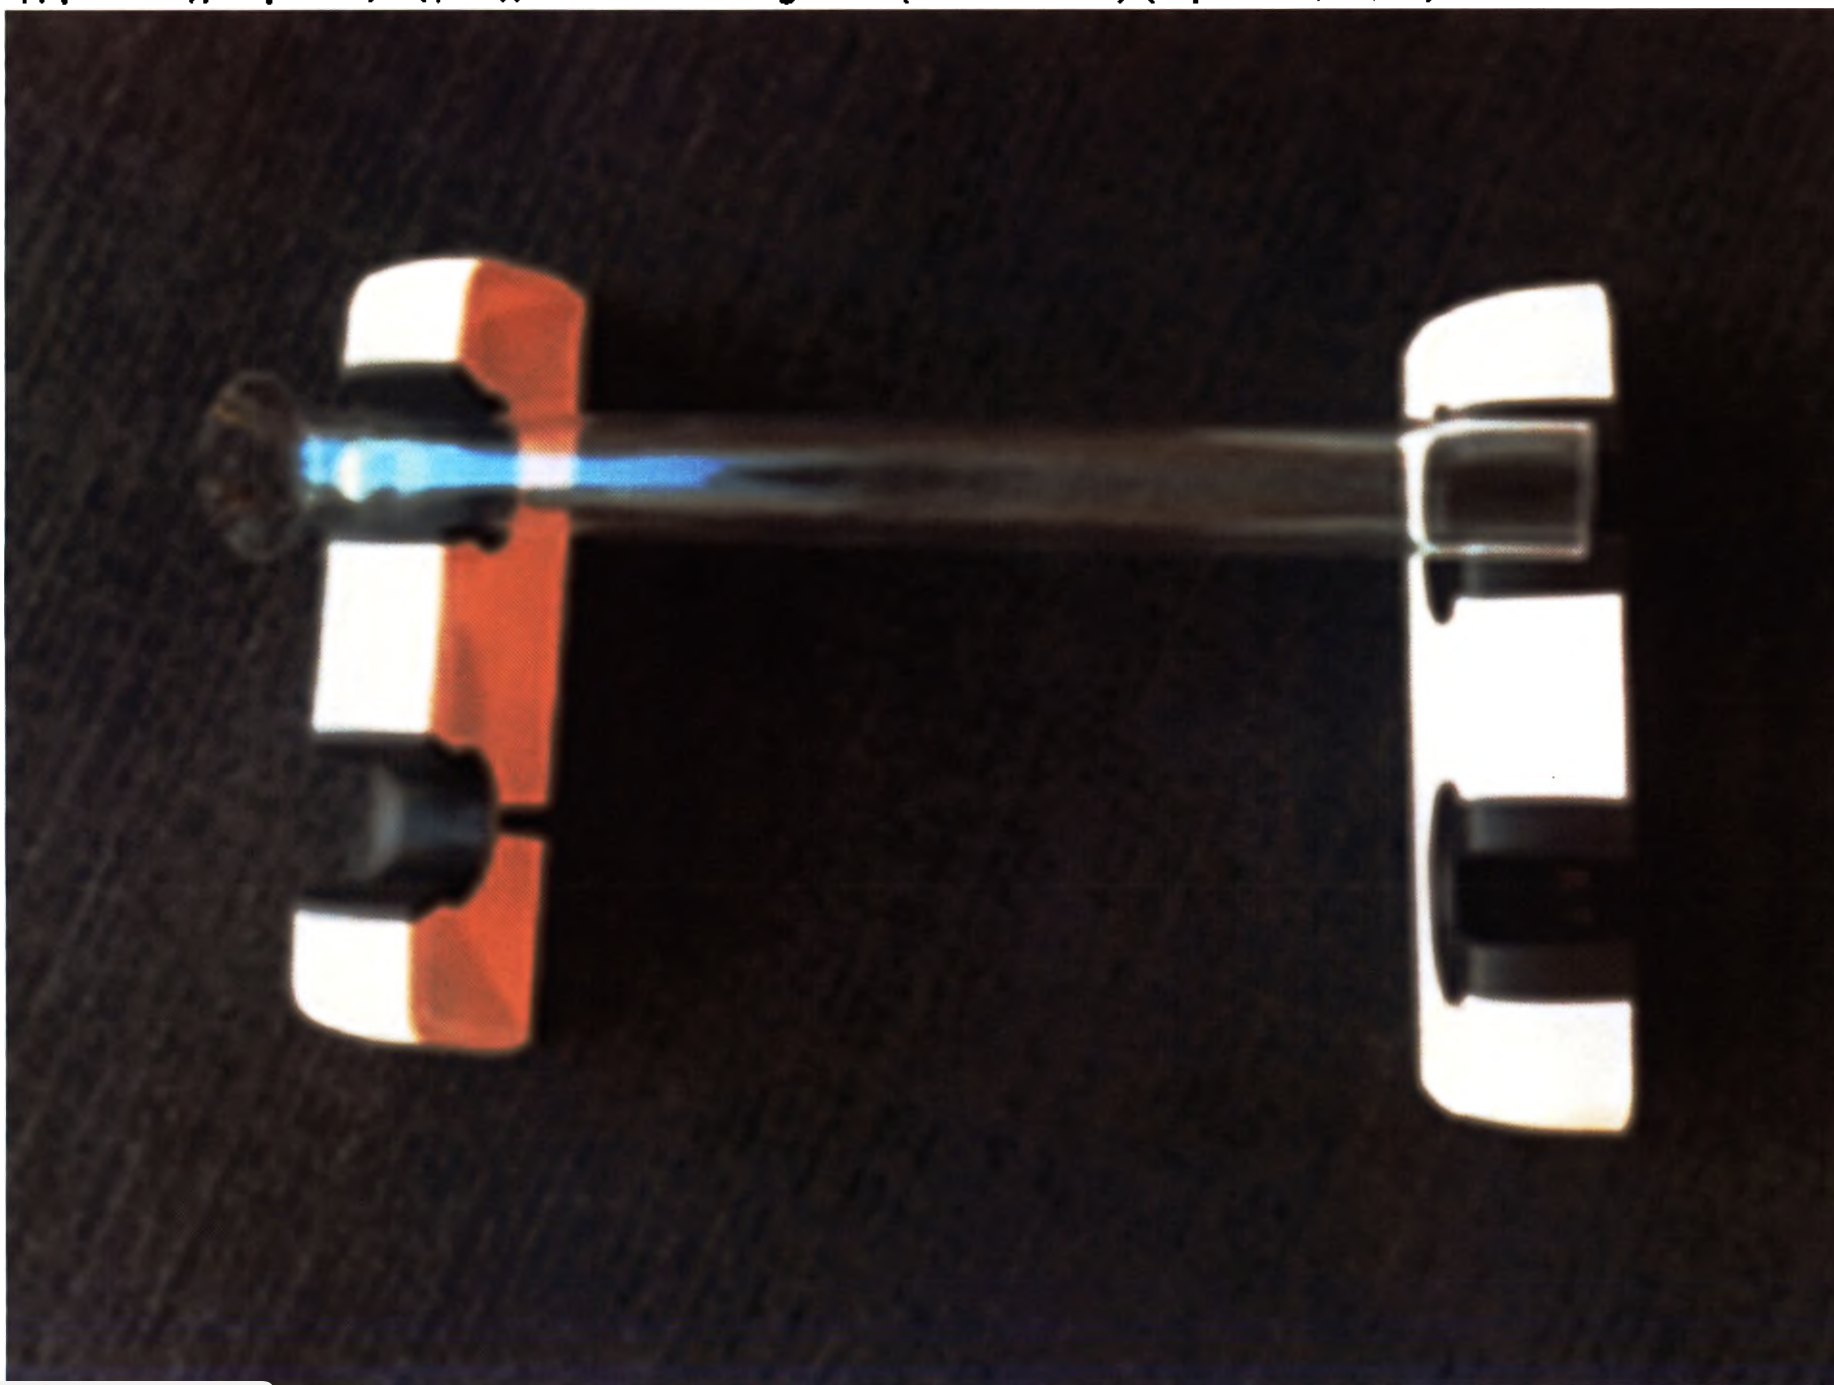


Загубники для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Загубники для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

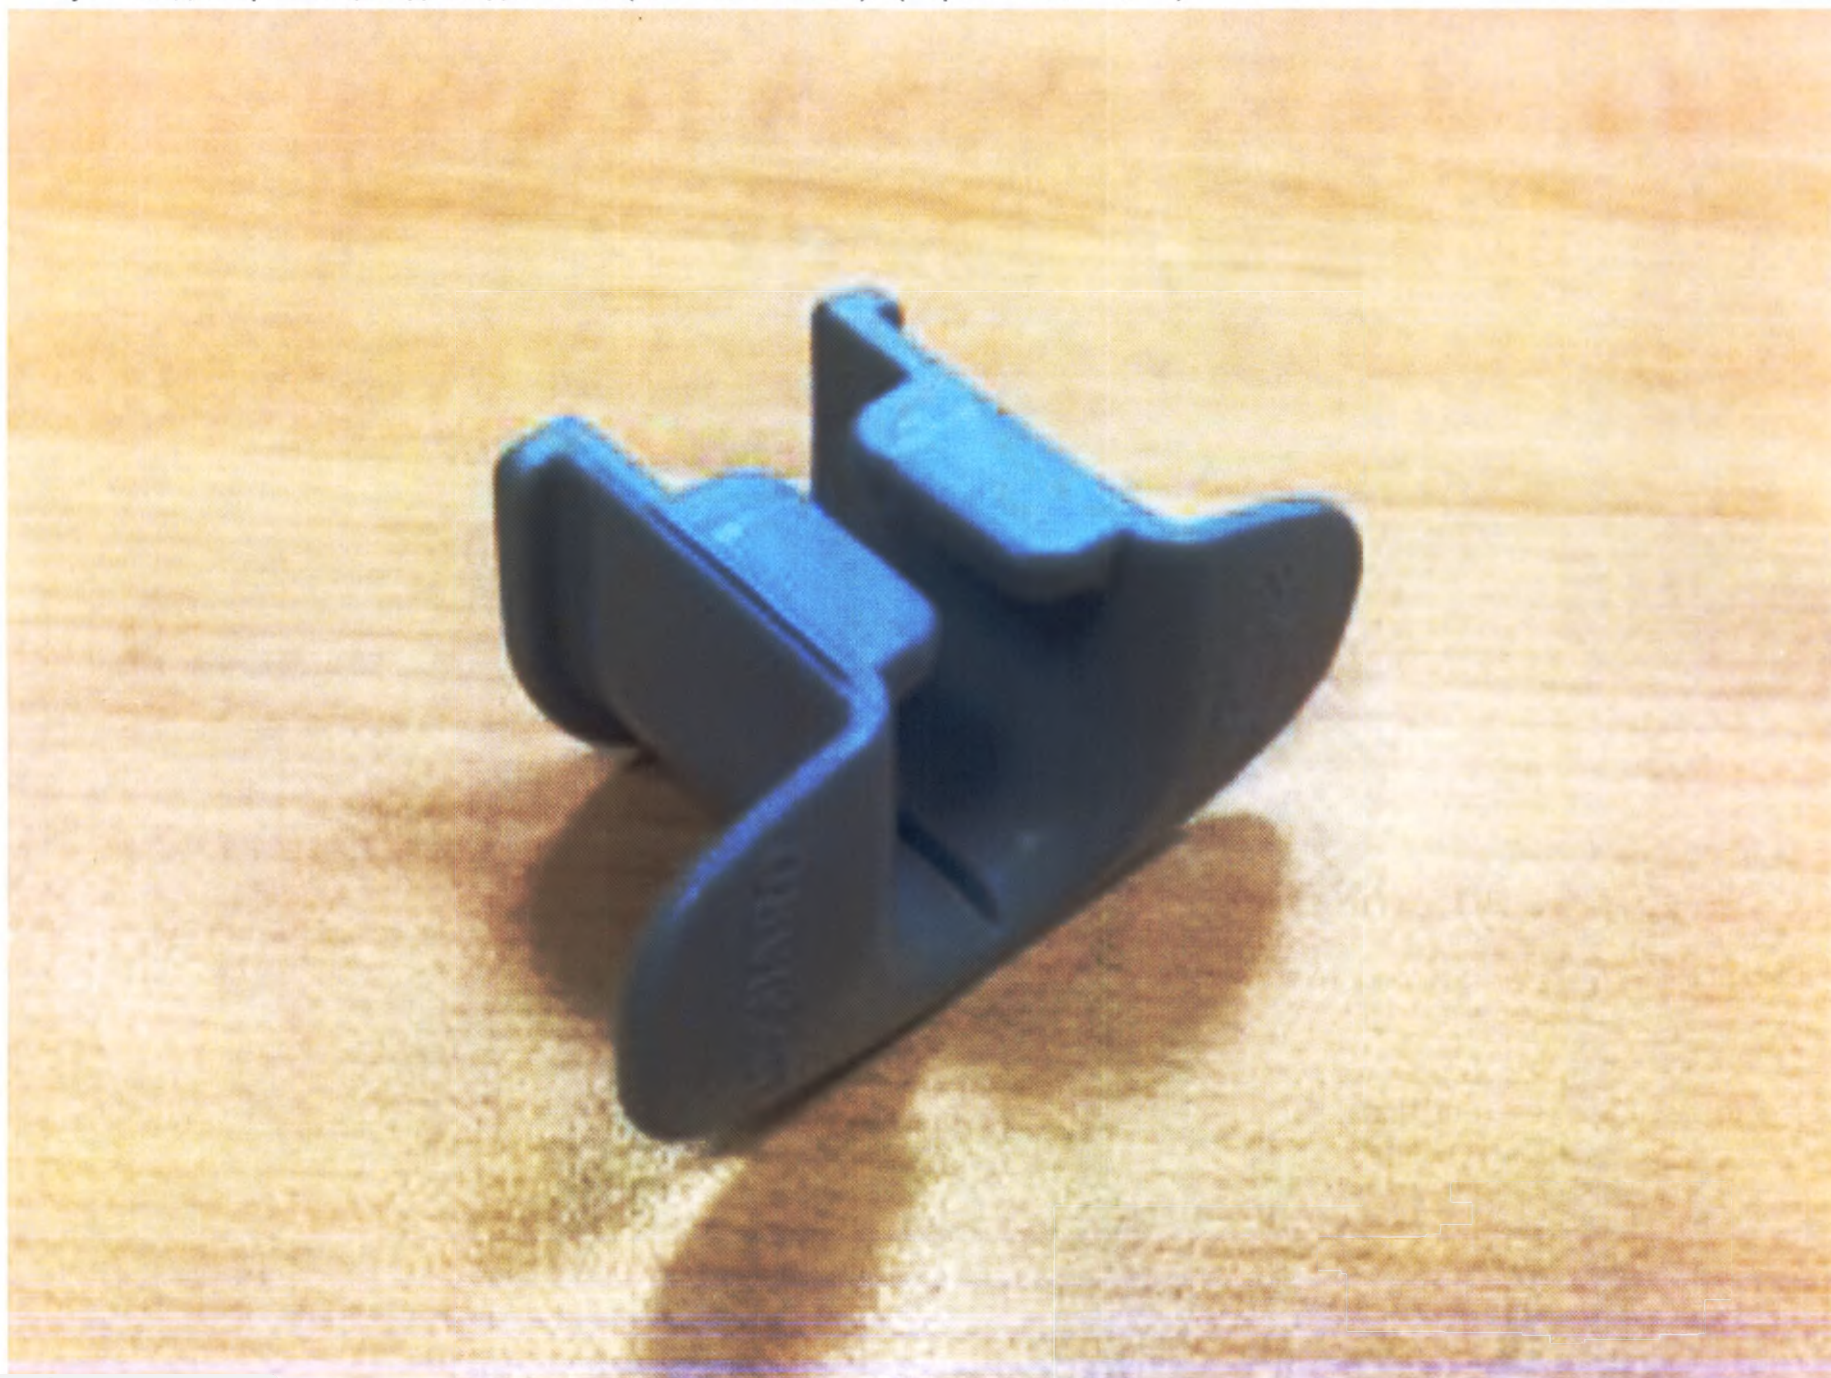


Загубники для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

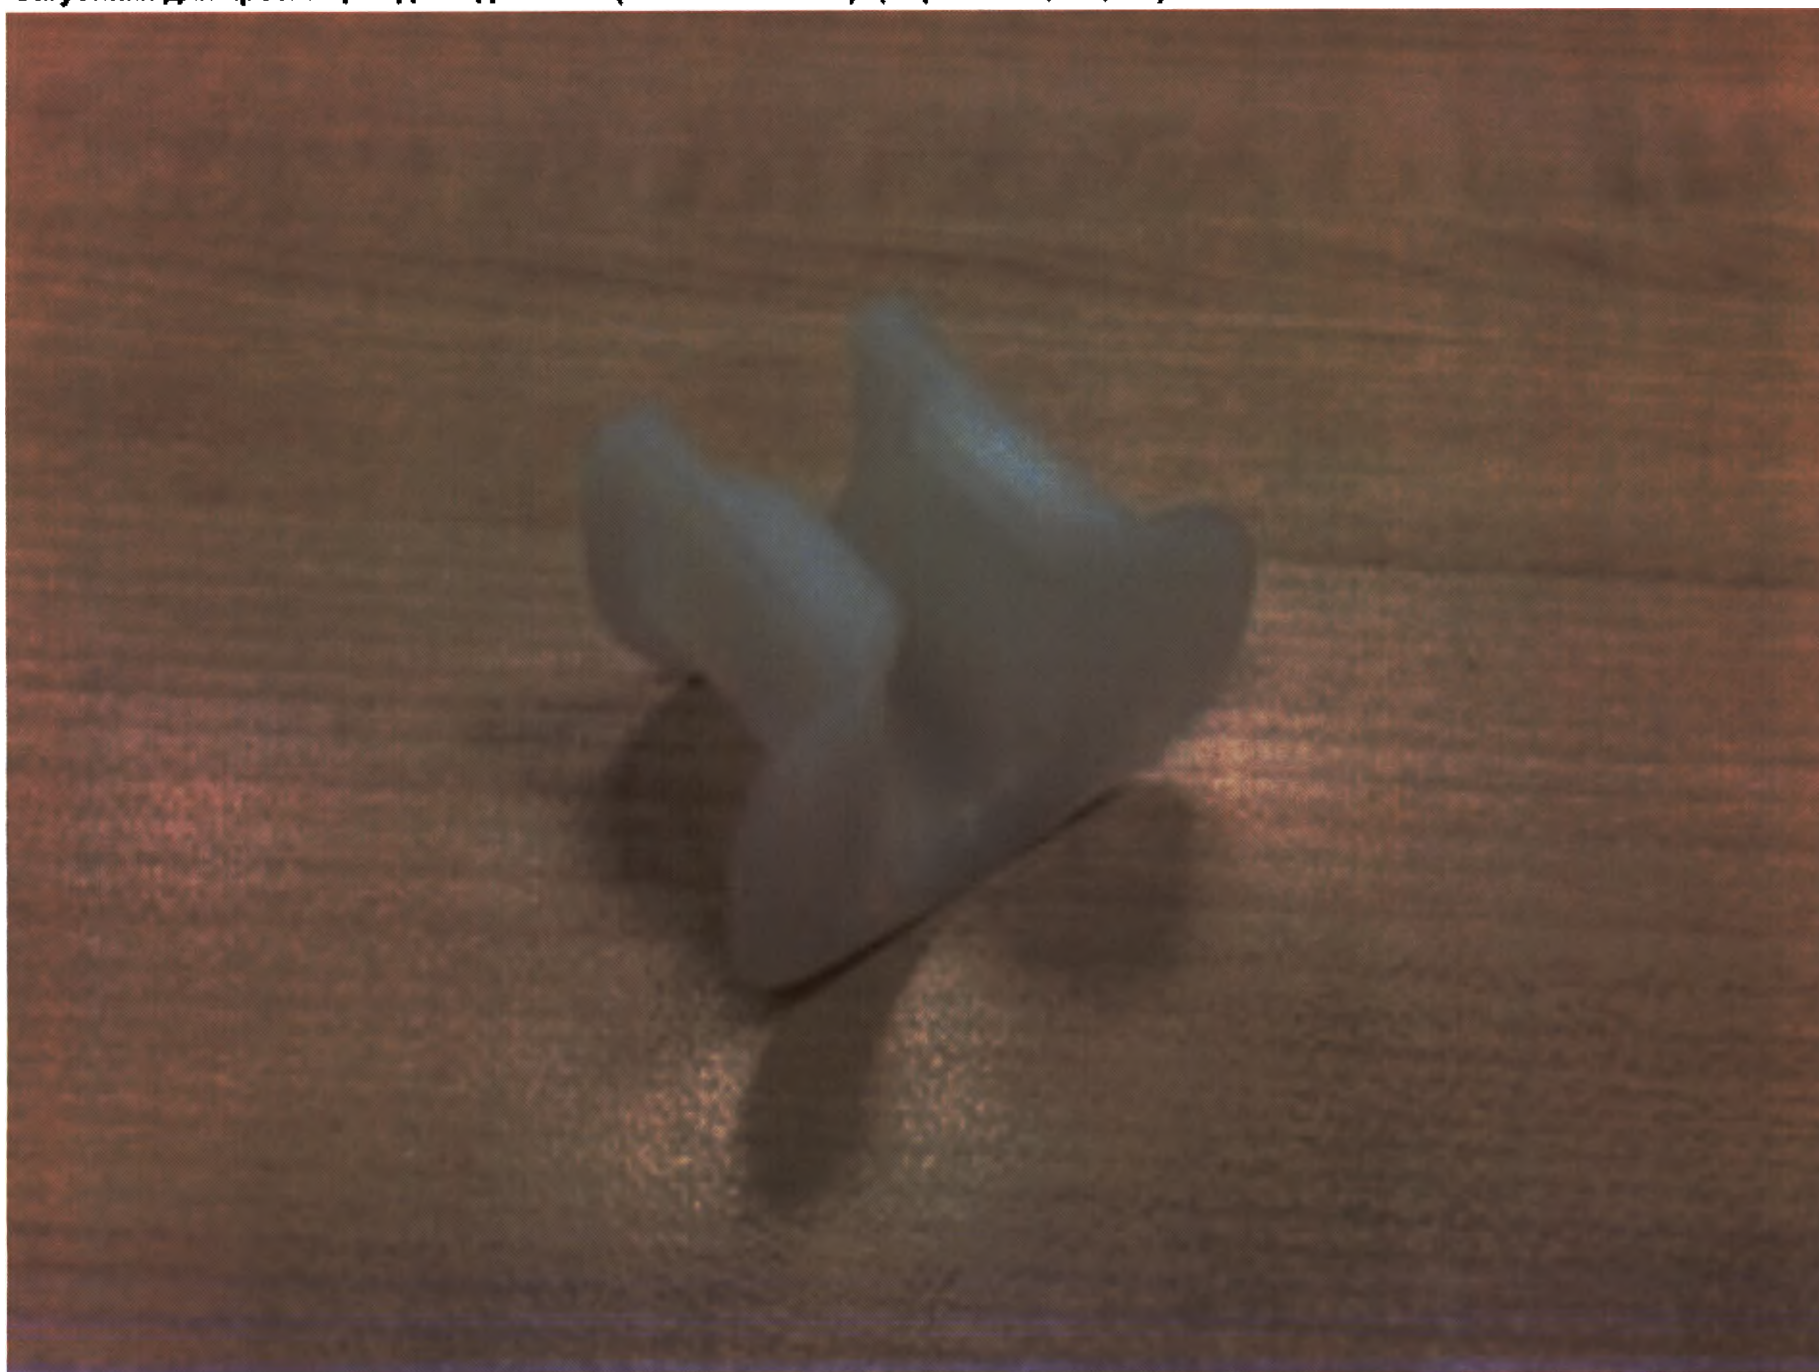

Загубники для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

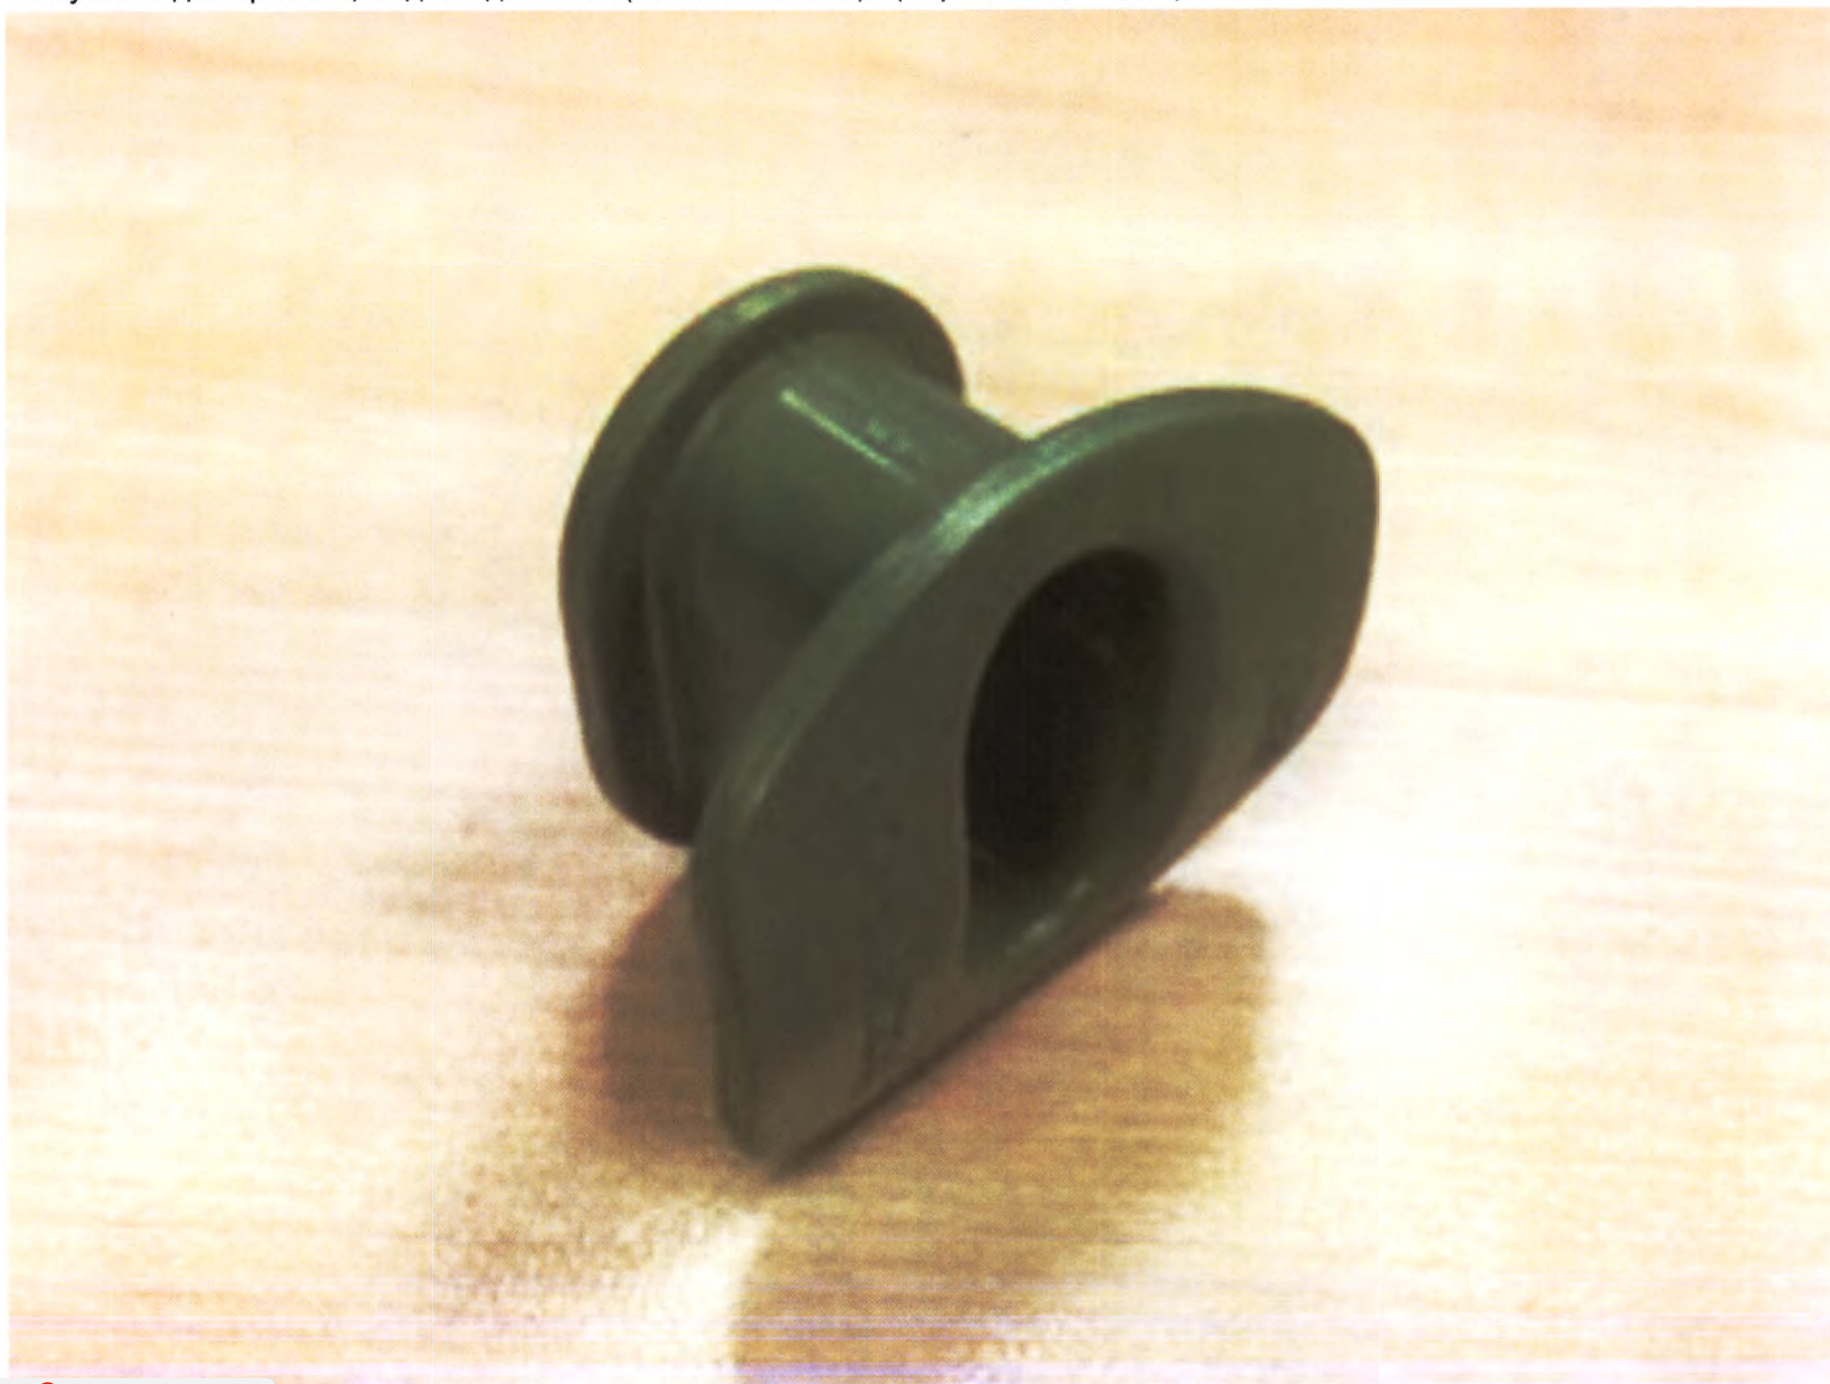

Загубники для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

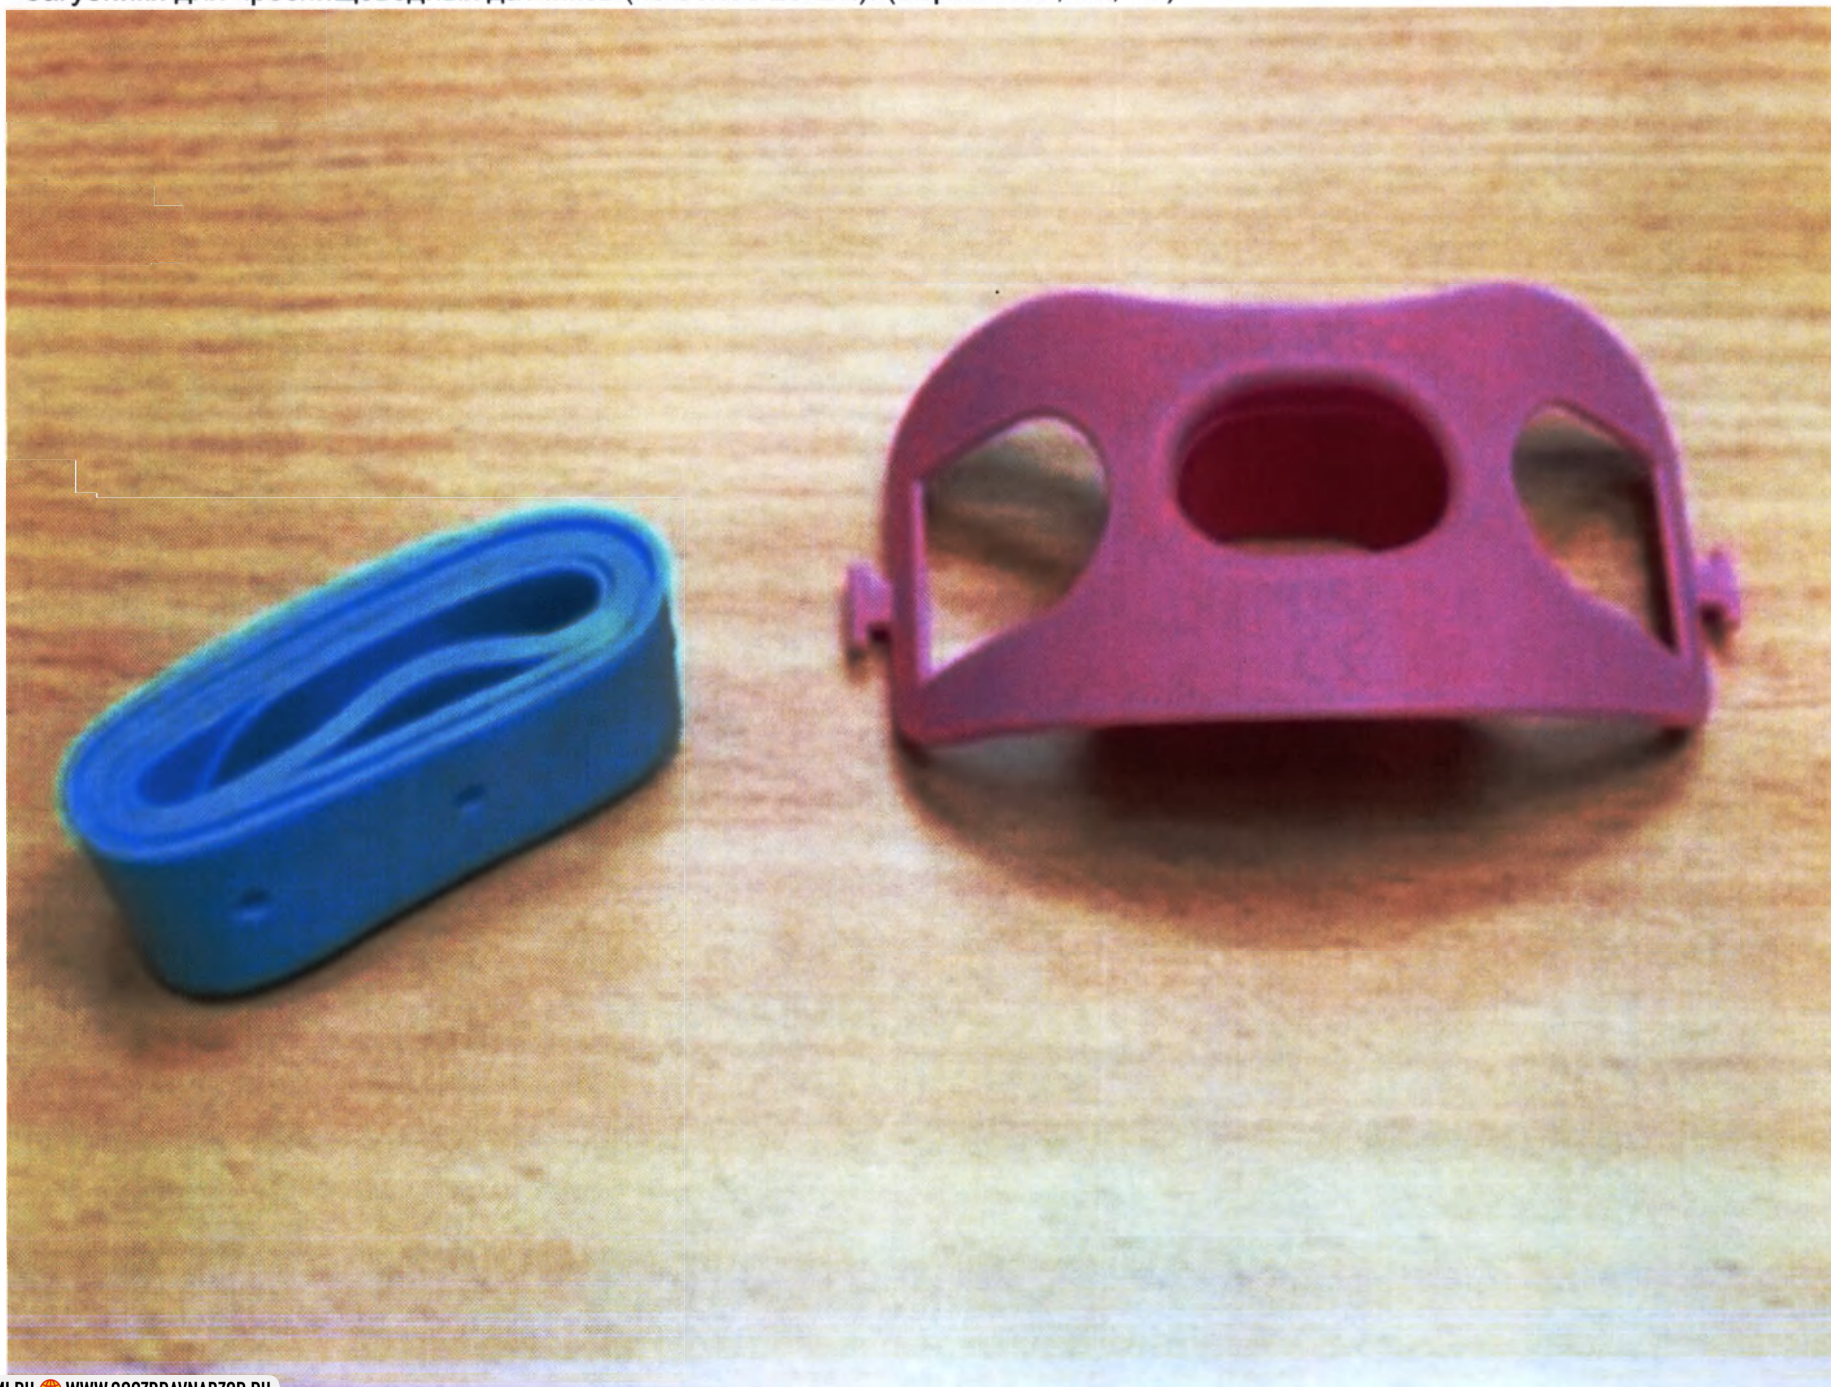

Защитные чехлы для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)





Защитные чехлы для чреспищеводных датчиков (не более 20 шт.). (Версии: R2, R3, R4)





Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера CW Doppler.
(Версии: R3, R4)

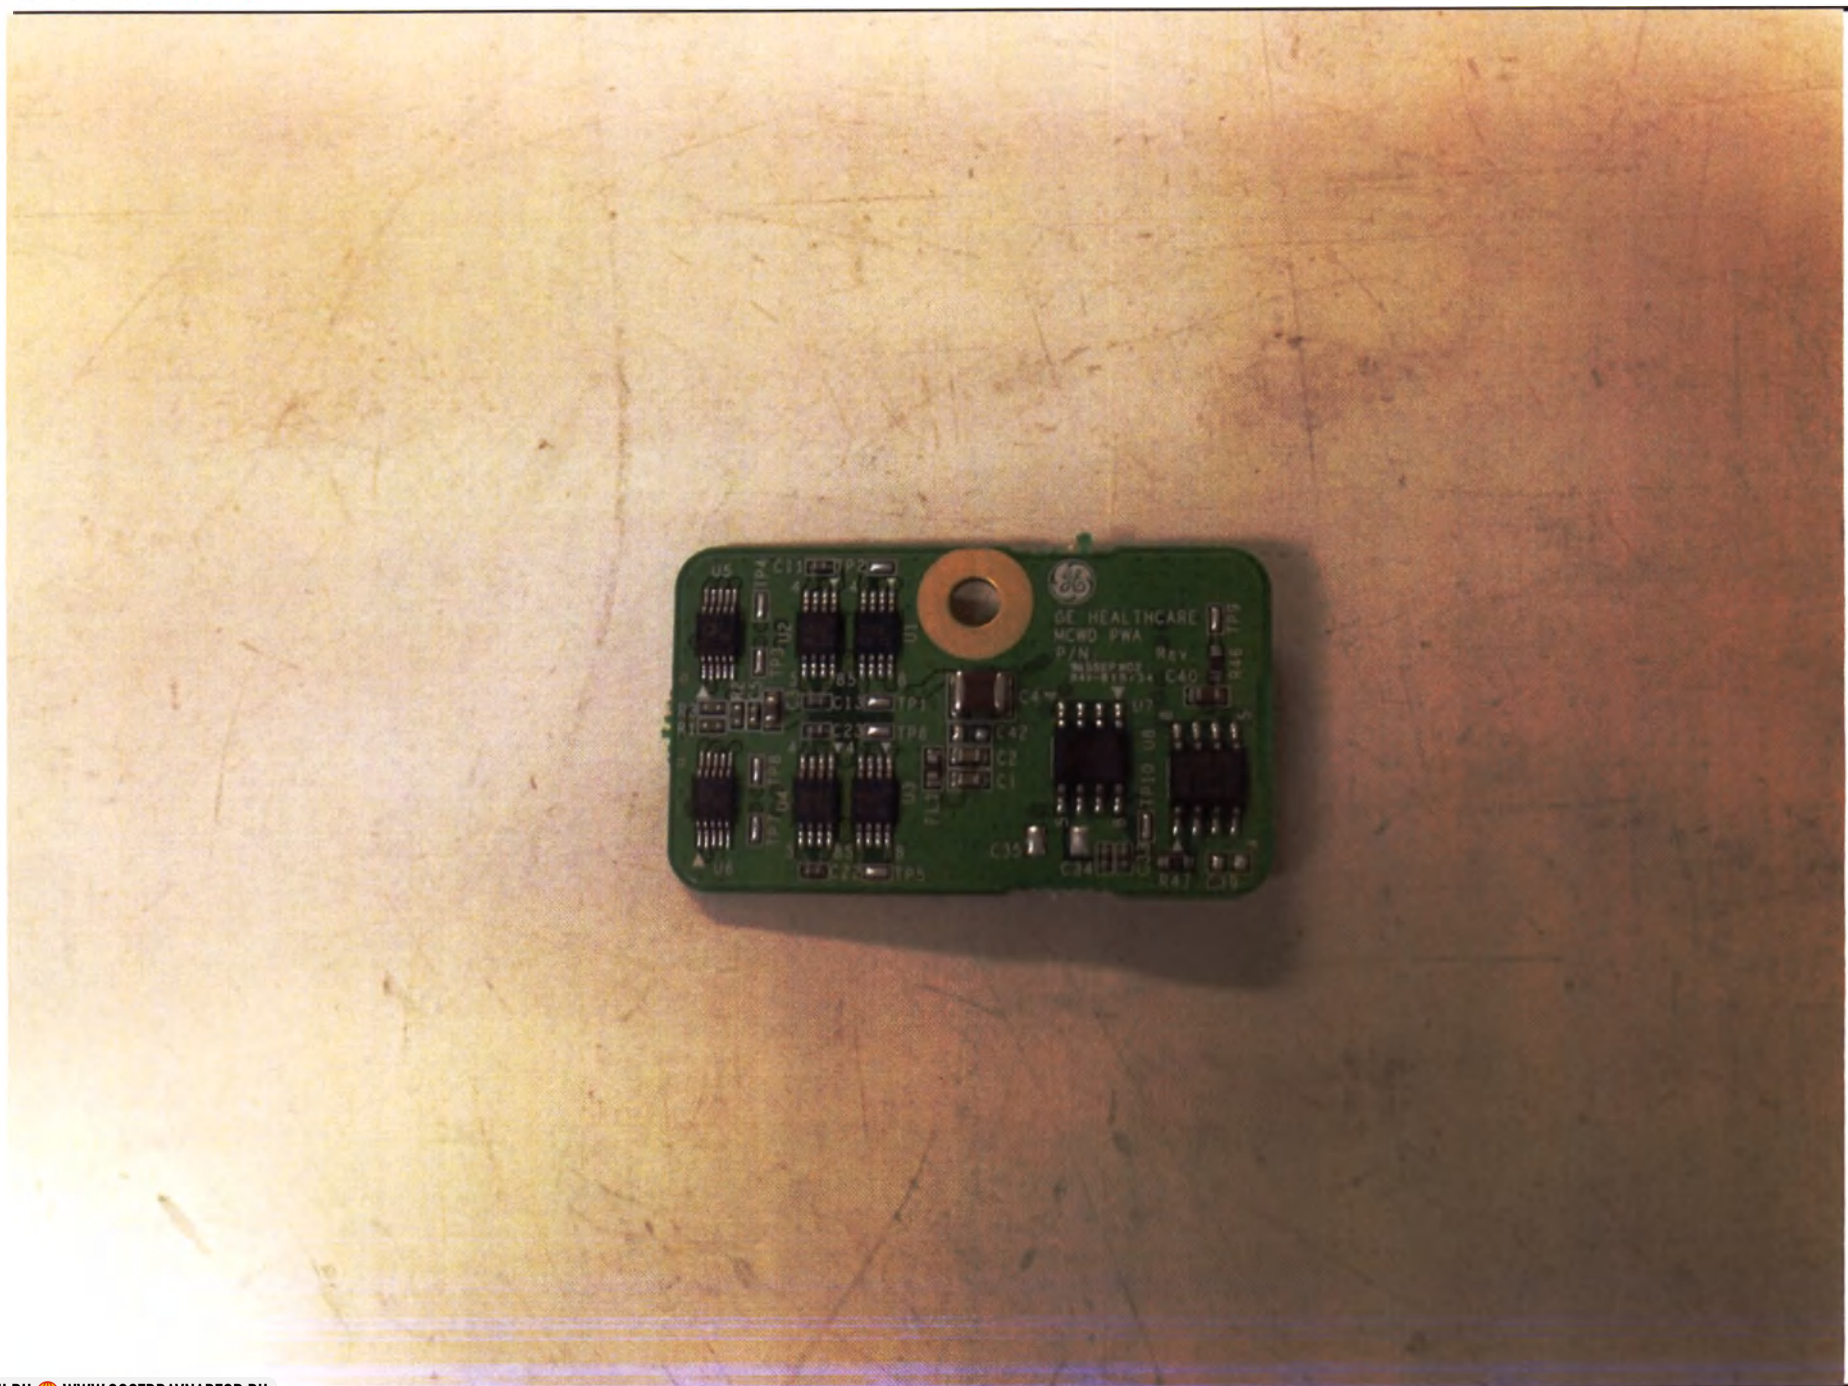

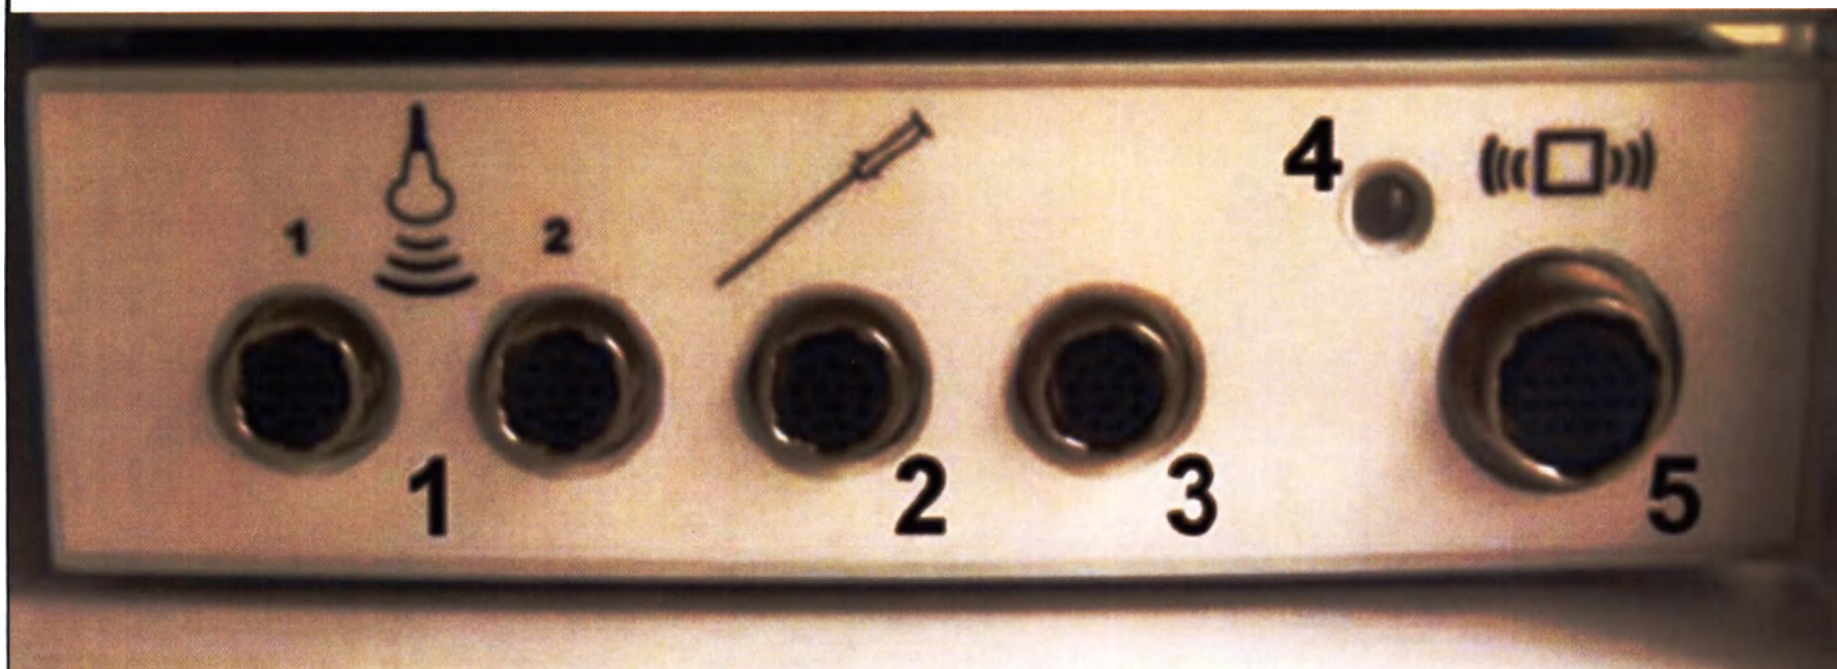


Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации (не более 10 шт.).
(Версии: R2, R3, R4)



Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации (не более 10 шт.).
(Версии: R2, R3, R4)



Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации (не более 10 шт.).
(Версии: R2, R3, R4)

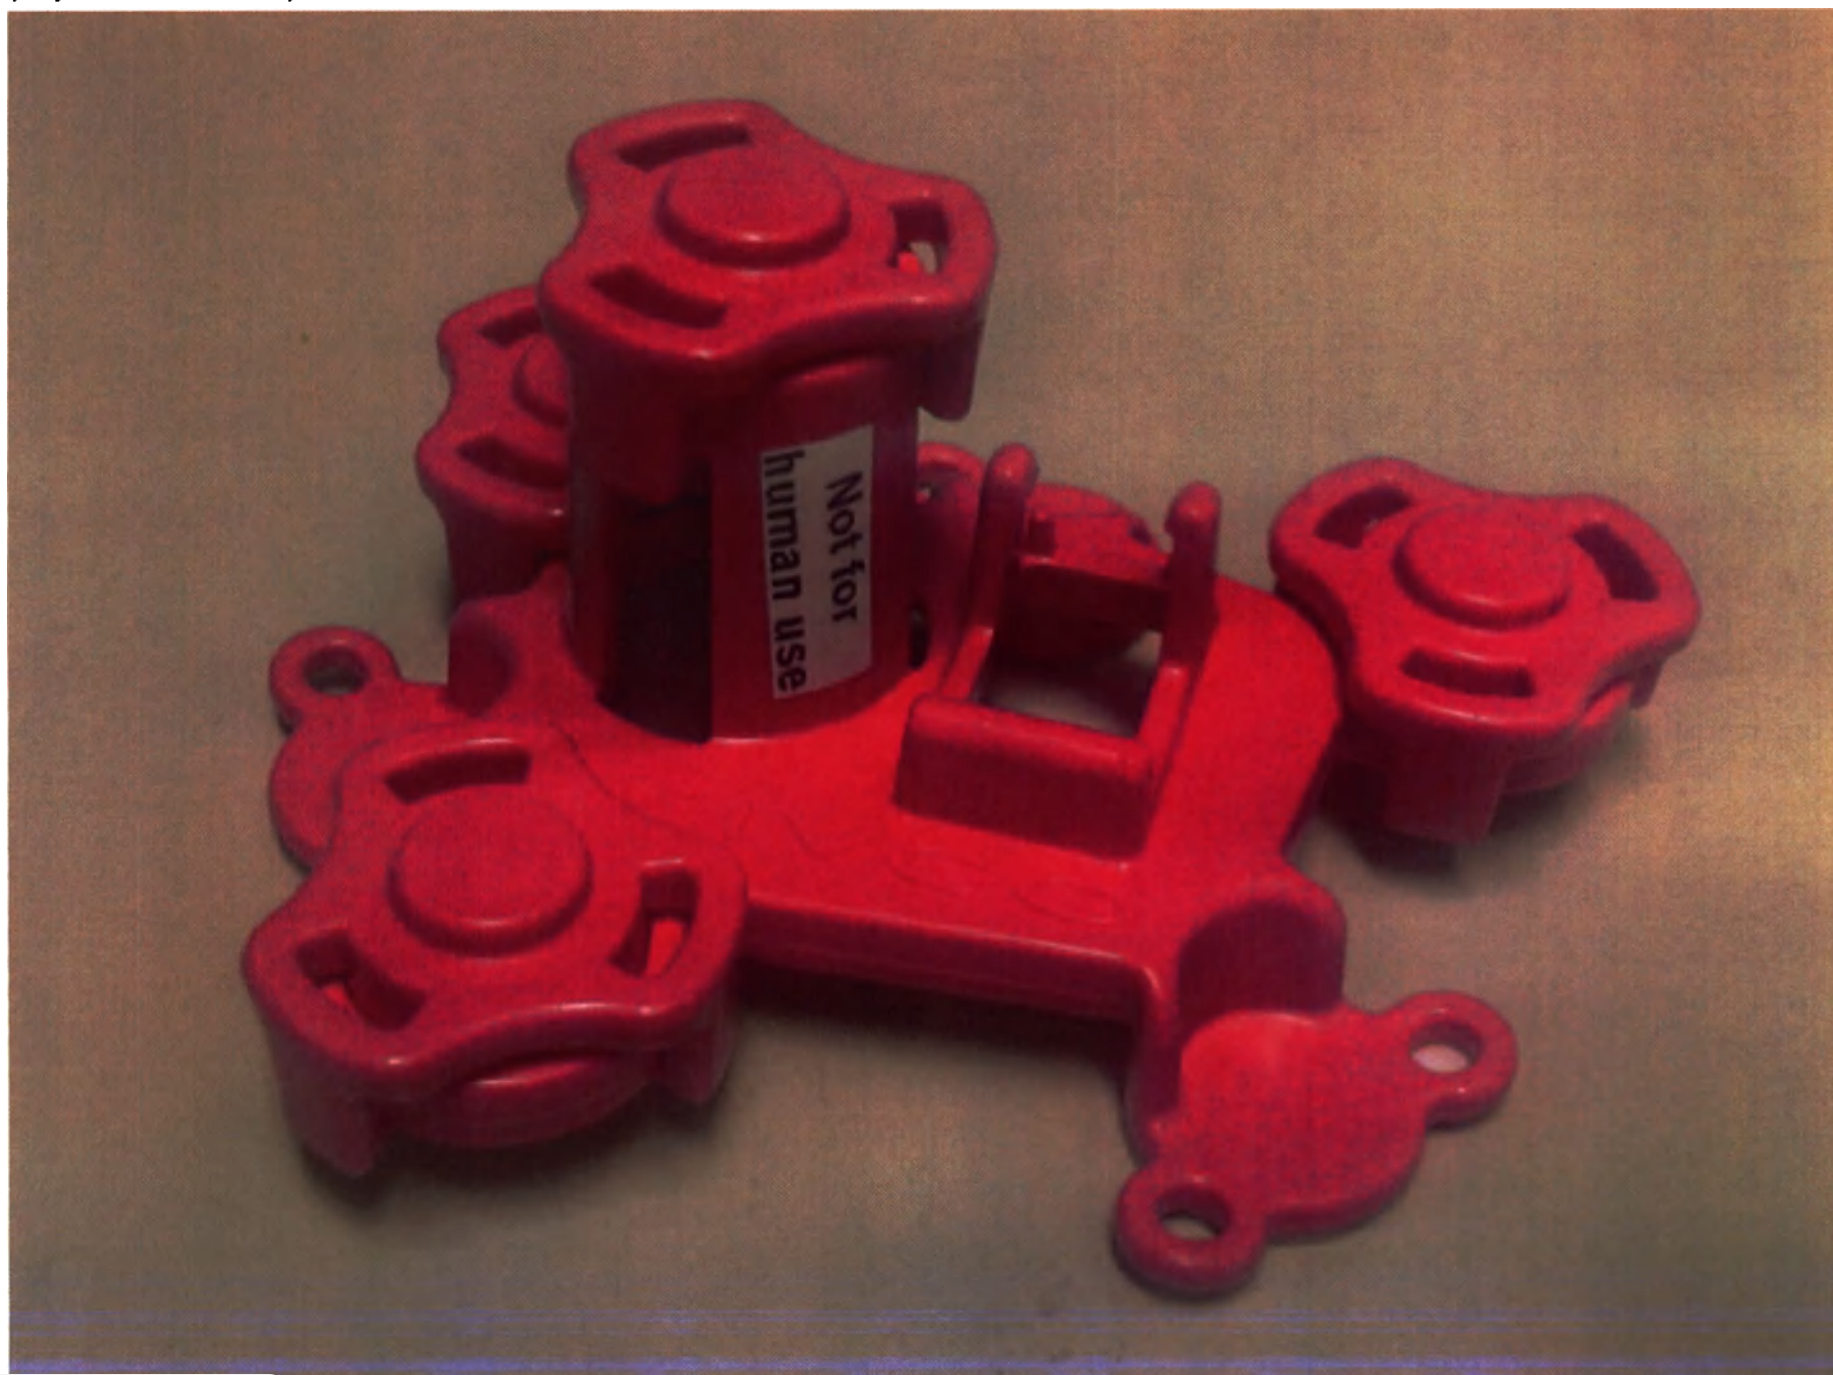

Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации (не более 10 шт.).
(Версии: R2, R3, R4)




Стойка для объемной навигации. (Версии: R2, R3, R4)



Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Needle Tip Tracker. (Версии: R2, R3, R4)




Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Virtual Tip Tracker. (не более 10 шт.).
(Версии: R2, R3, R4)

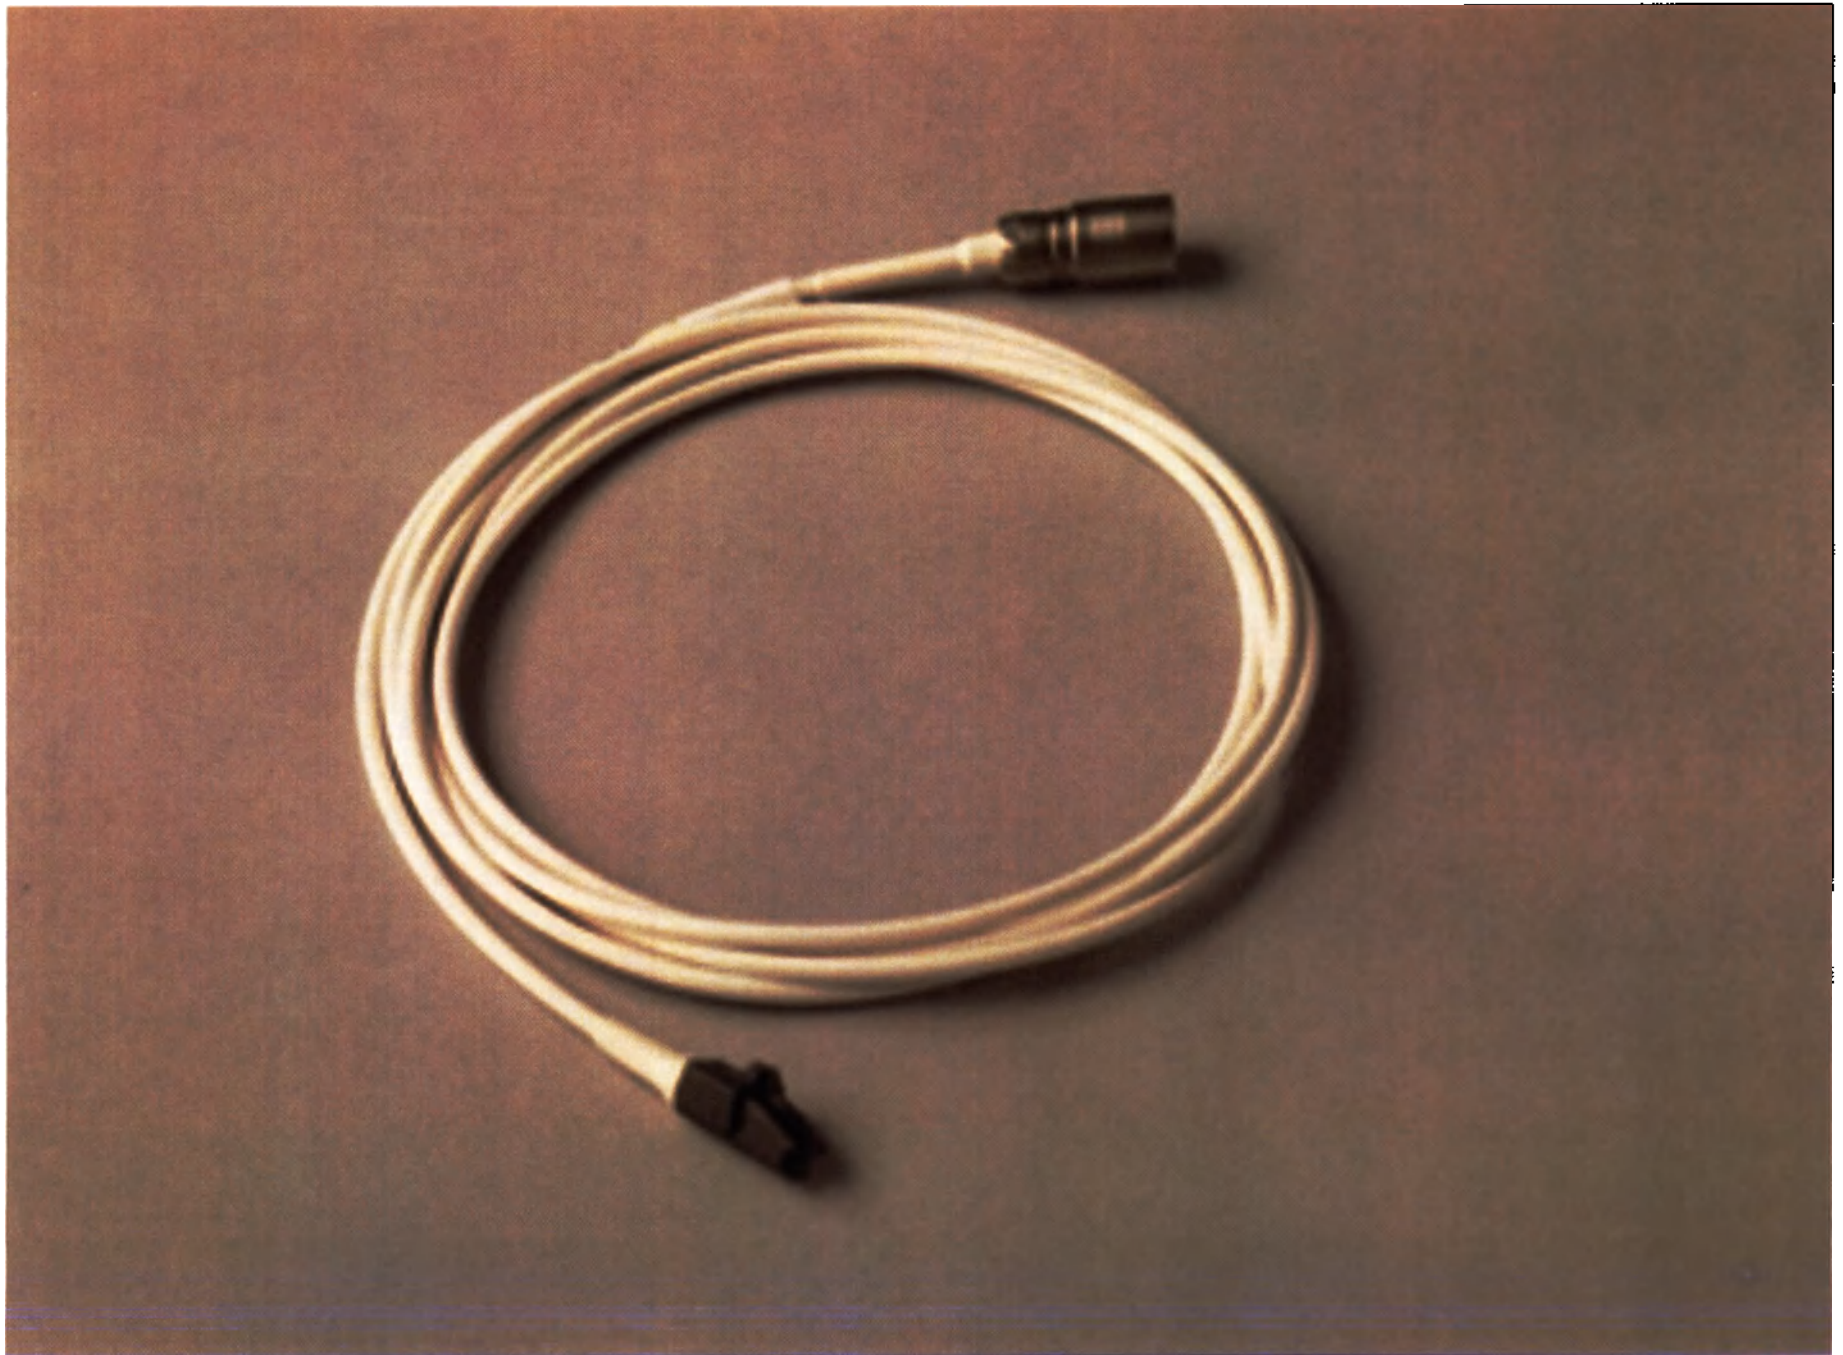

Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Virtual Tip Tracker. (не более 10 шт.).
(Версии: R2, R3, R4)



Устройство для получения объемных медицинских ультразвуковых изображений в реальном масштабе времени - Real Time 4D
(не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

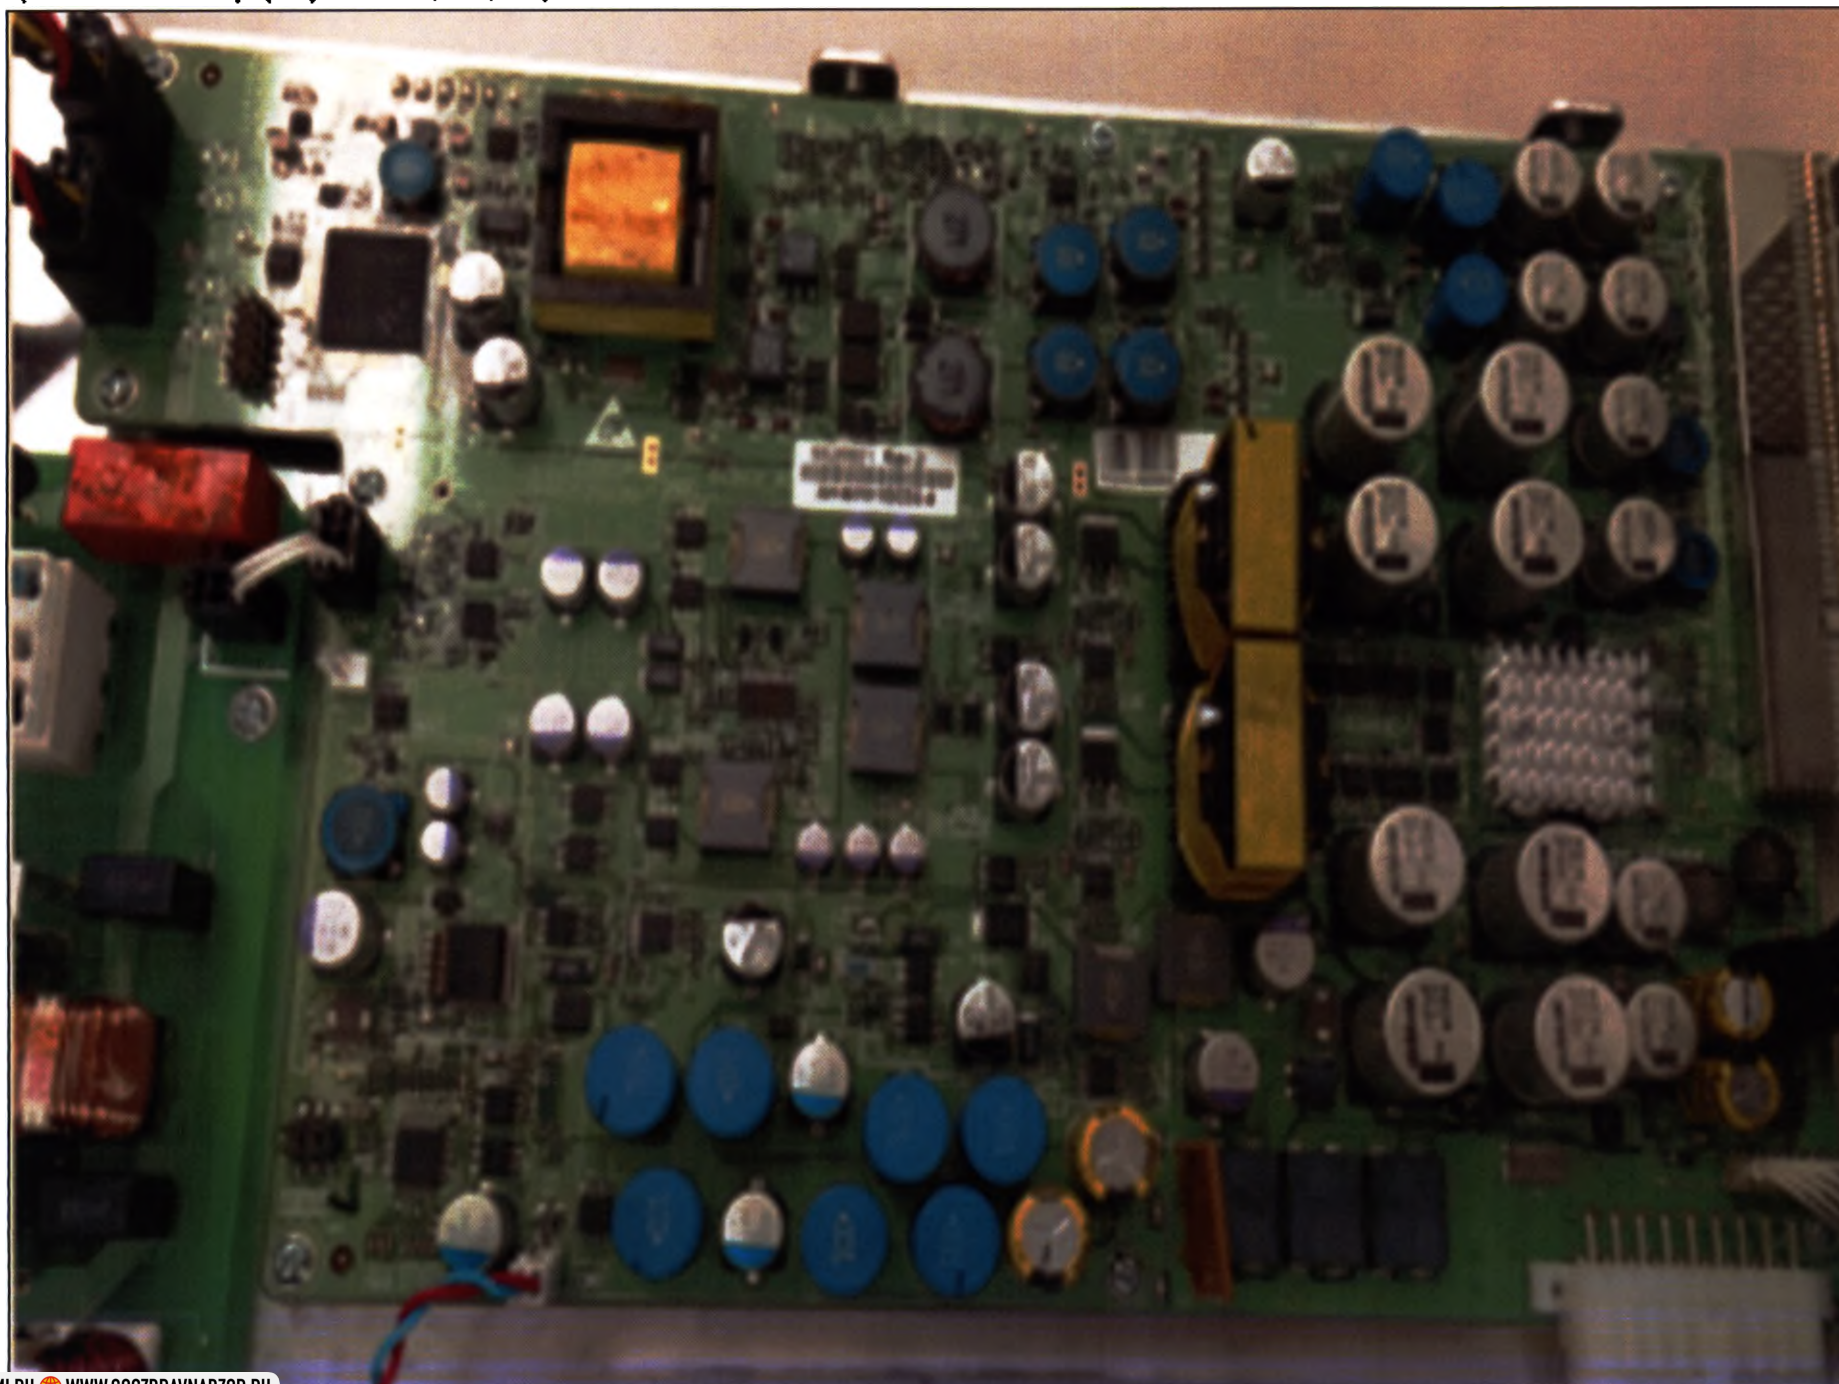





Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Advanced 3D. (Версии: R2, R3, R4)



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Tru 3D.(Версии: R2, R3, R4)



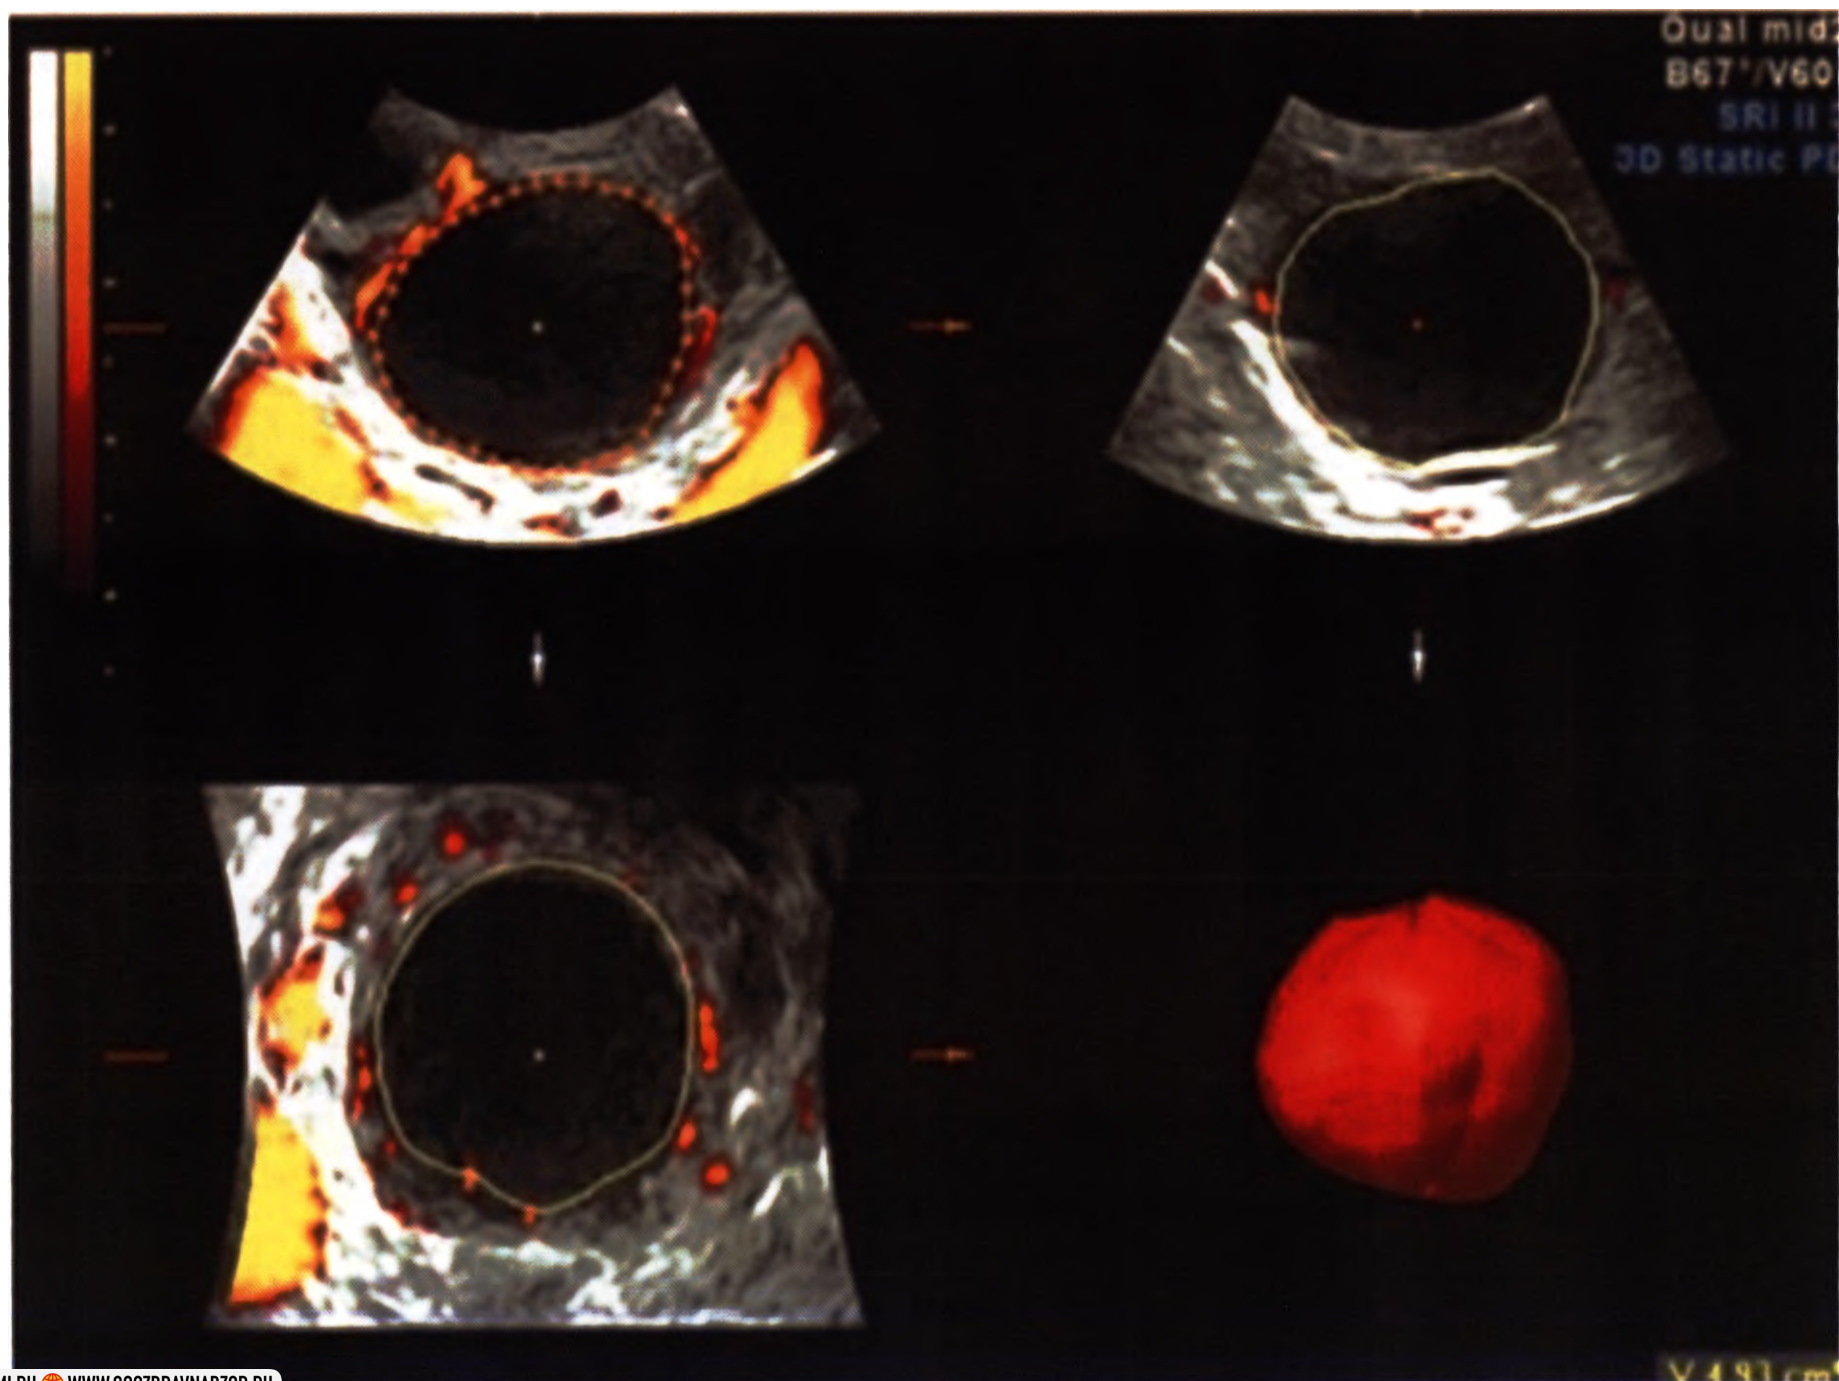

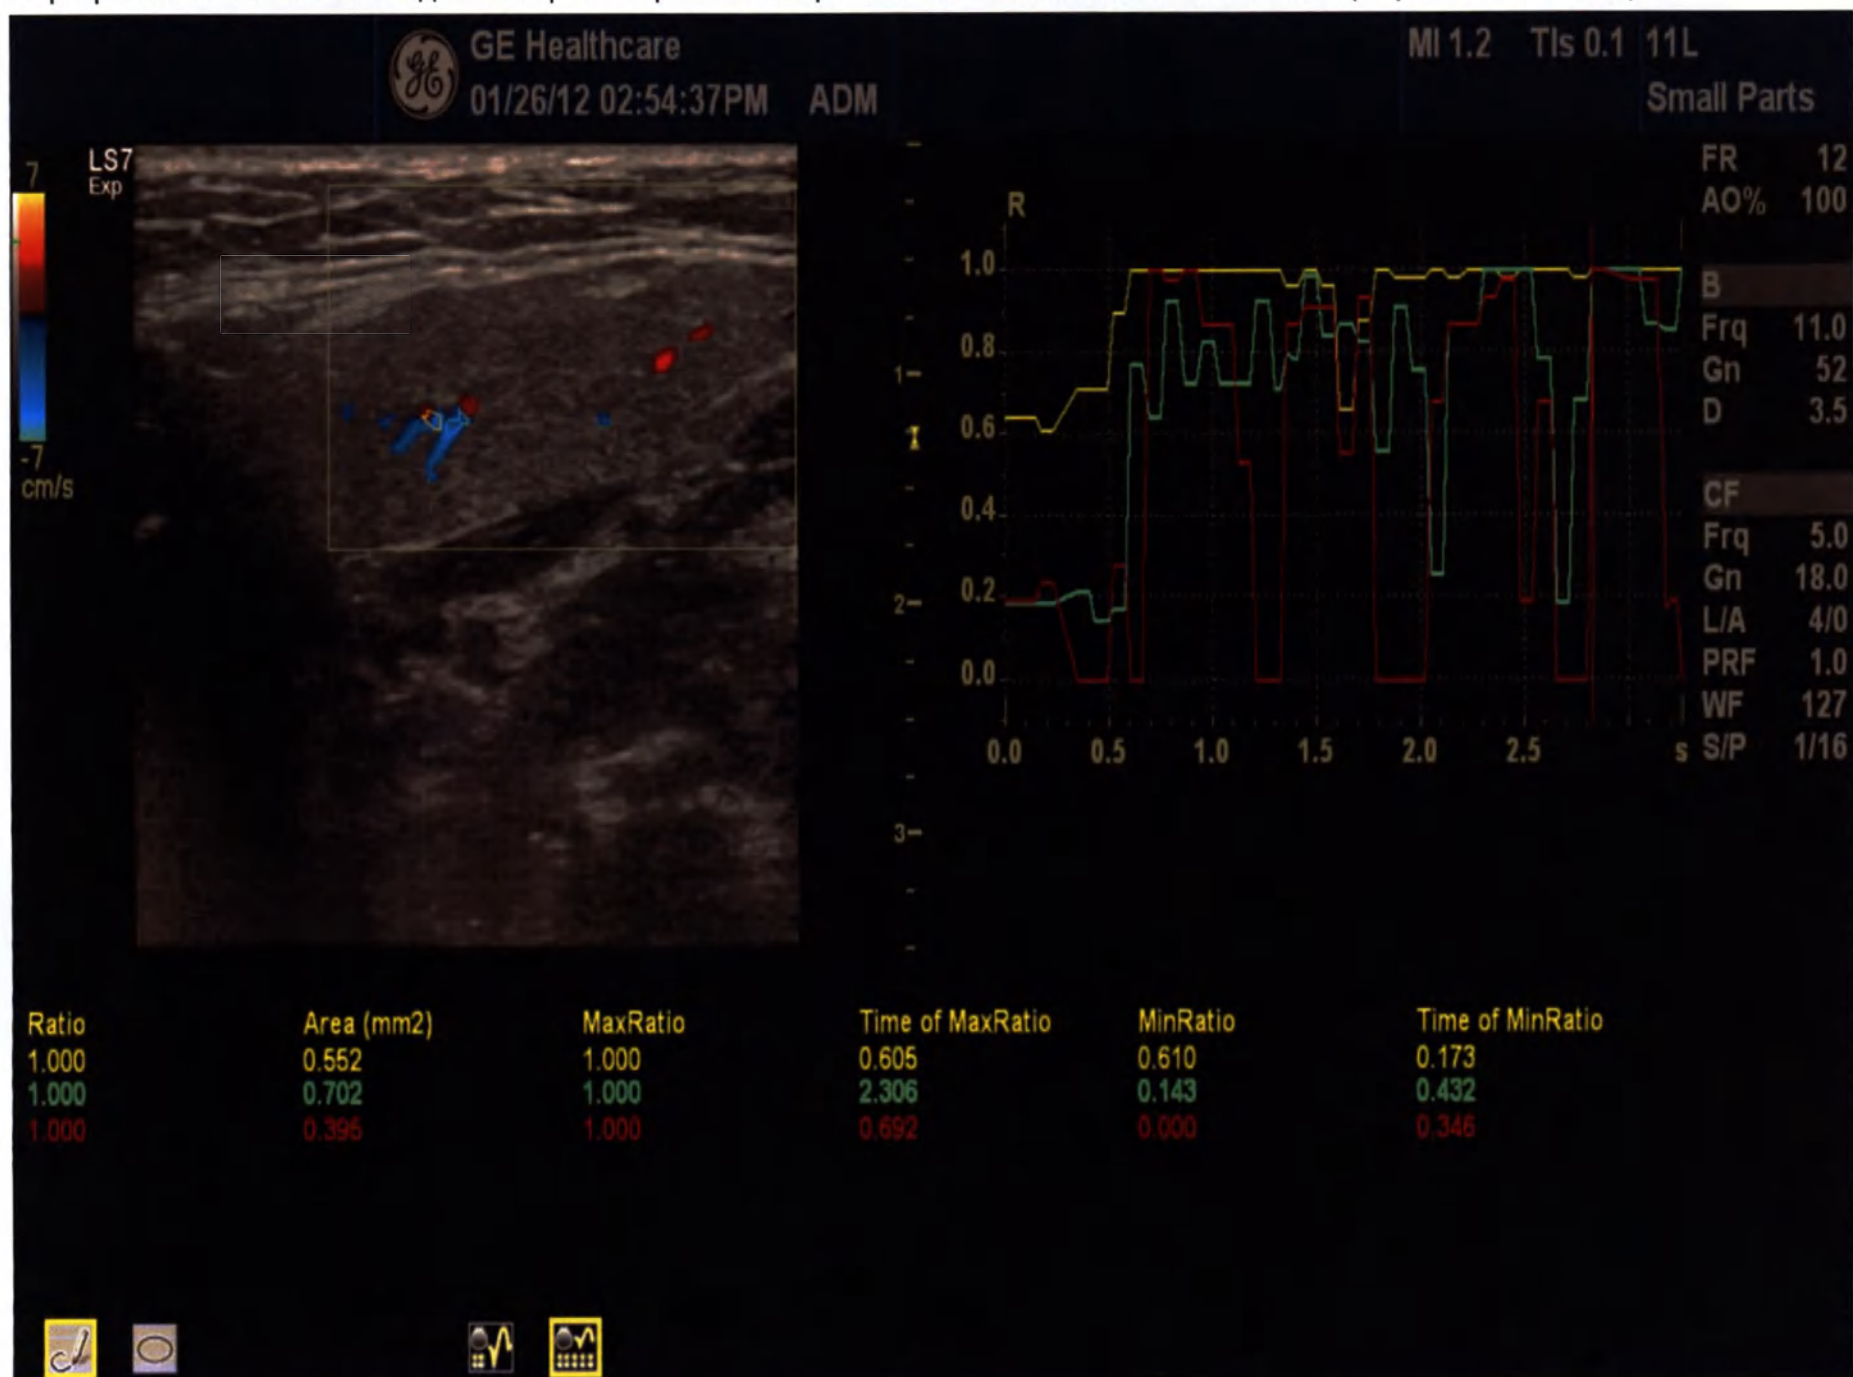

Программное обеспечение для улучшения изображения срезов в режиме 3D - VCI (Volume Contrast Imaging).(Версии: R2, R3, R4)




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме SRI - режим подавления зернистости. (Версии: R2, R3, R4)




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме CrossXBeam. (Версии: R2, R3, R4)




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме B-flow - не доплеровская визуализация кровотока. (Версии: R2, R3, R4)

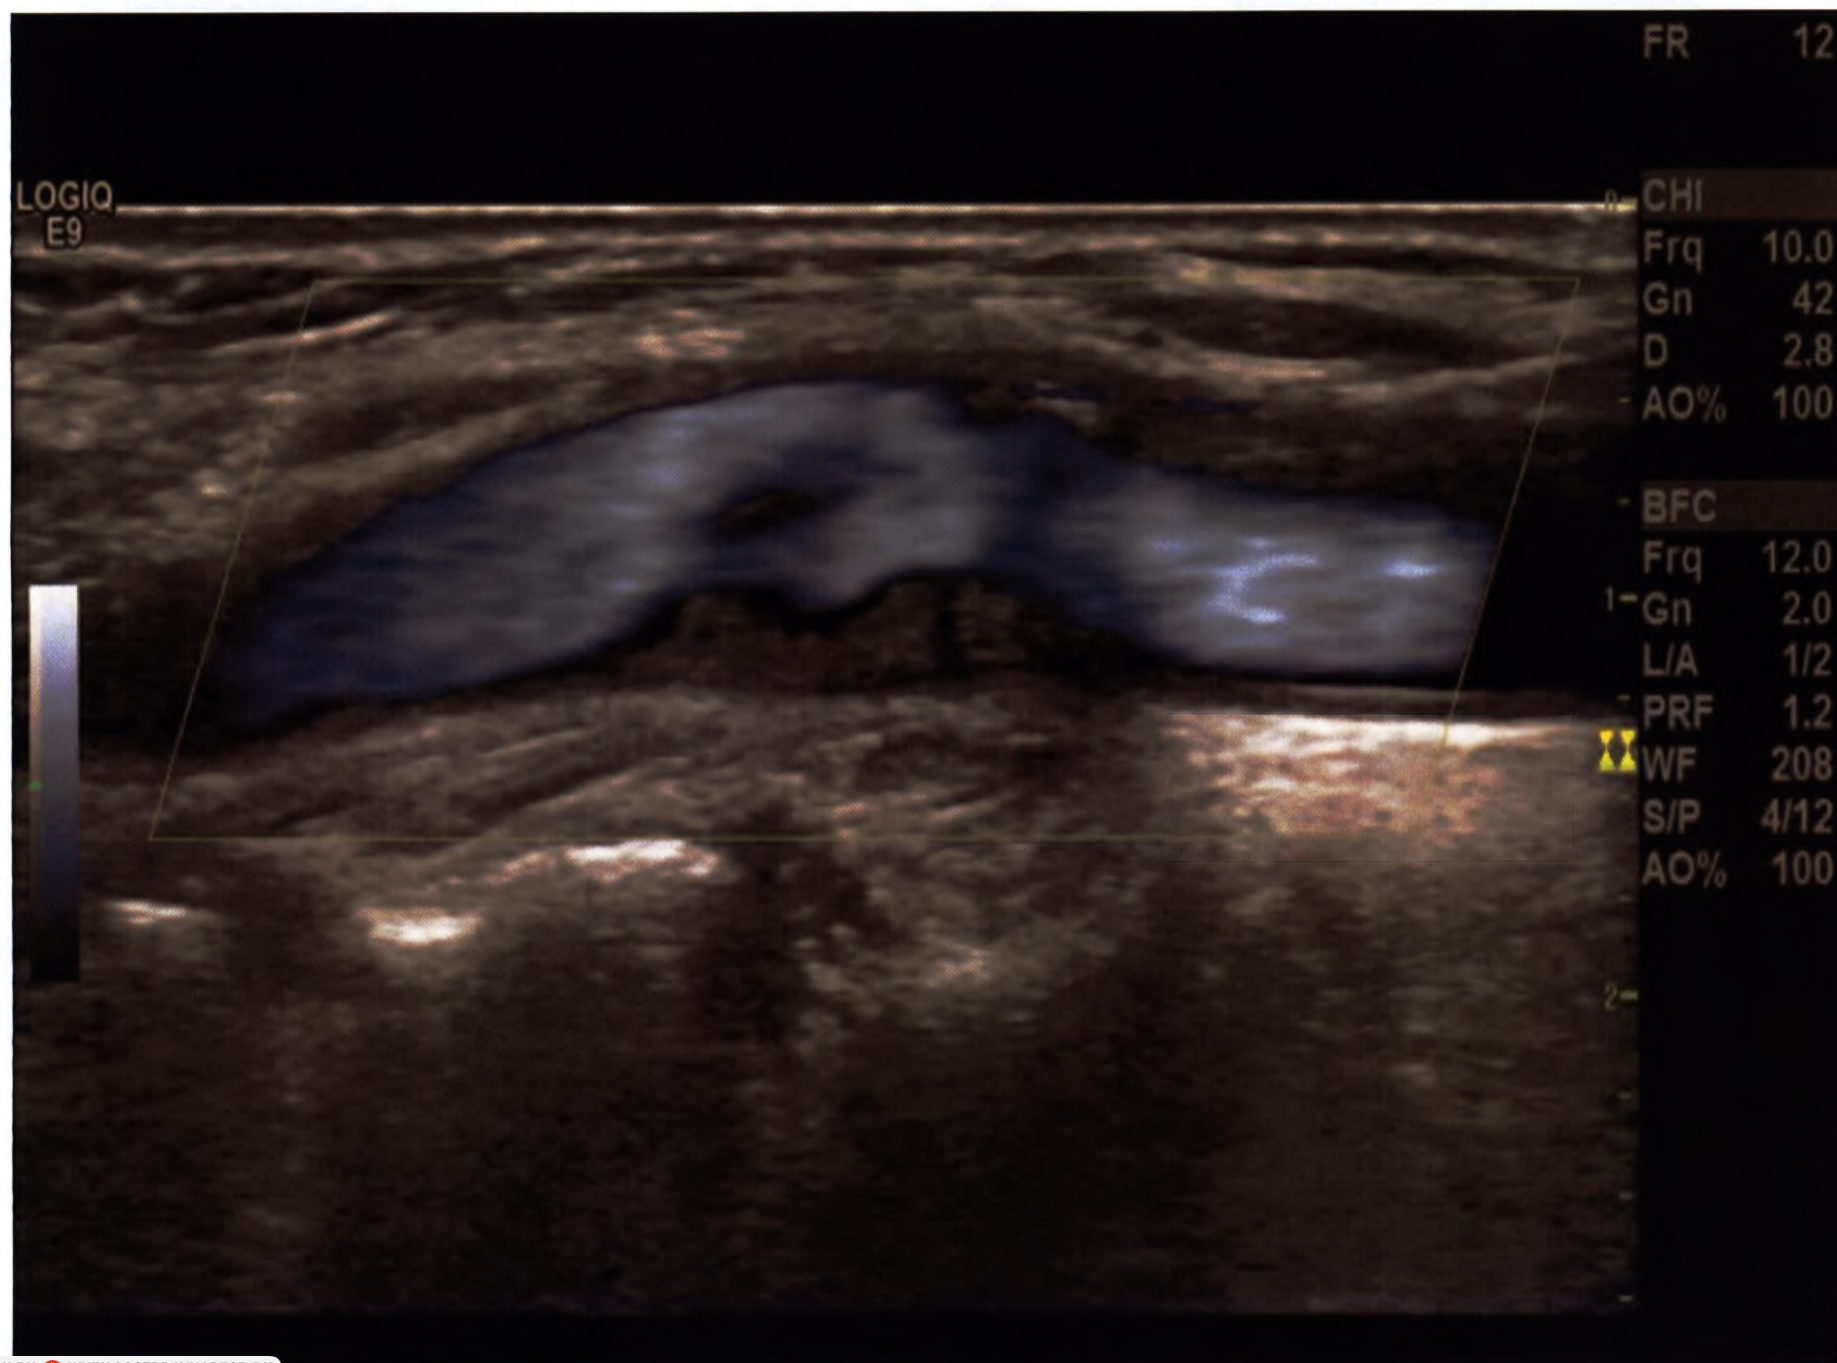

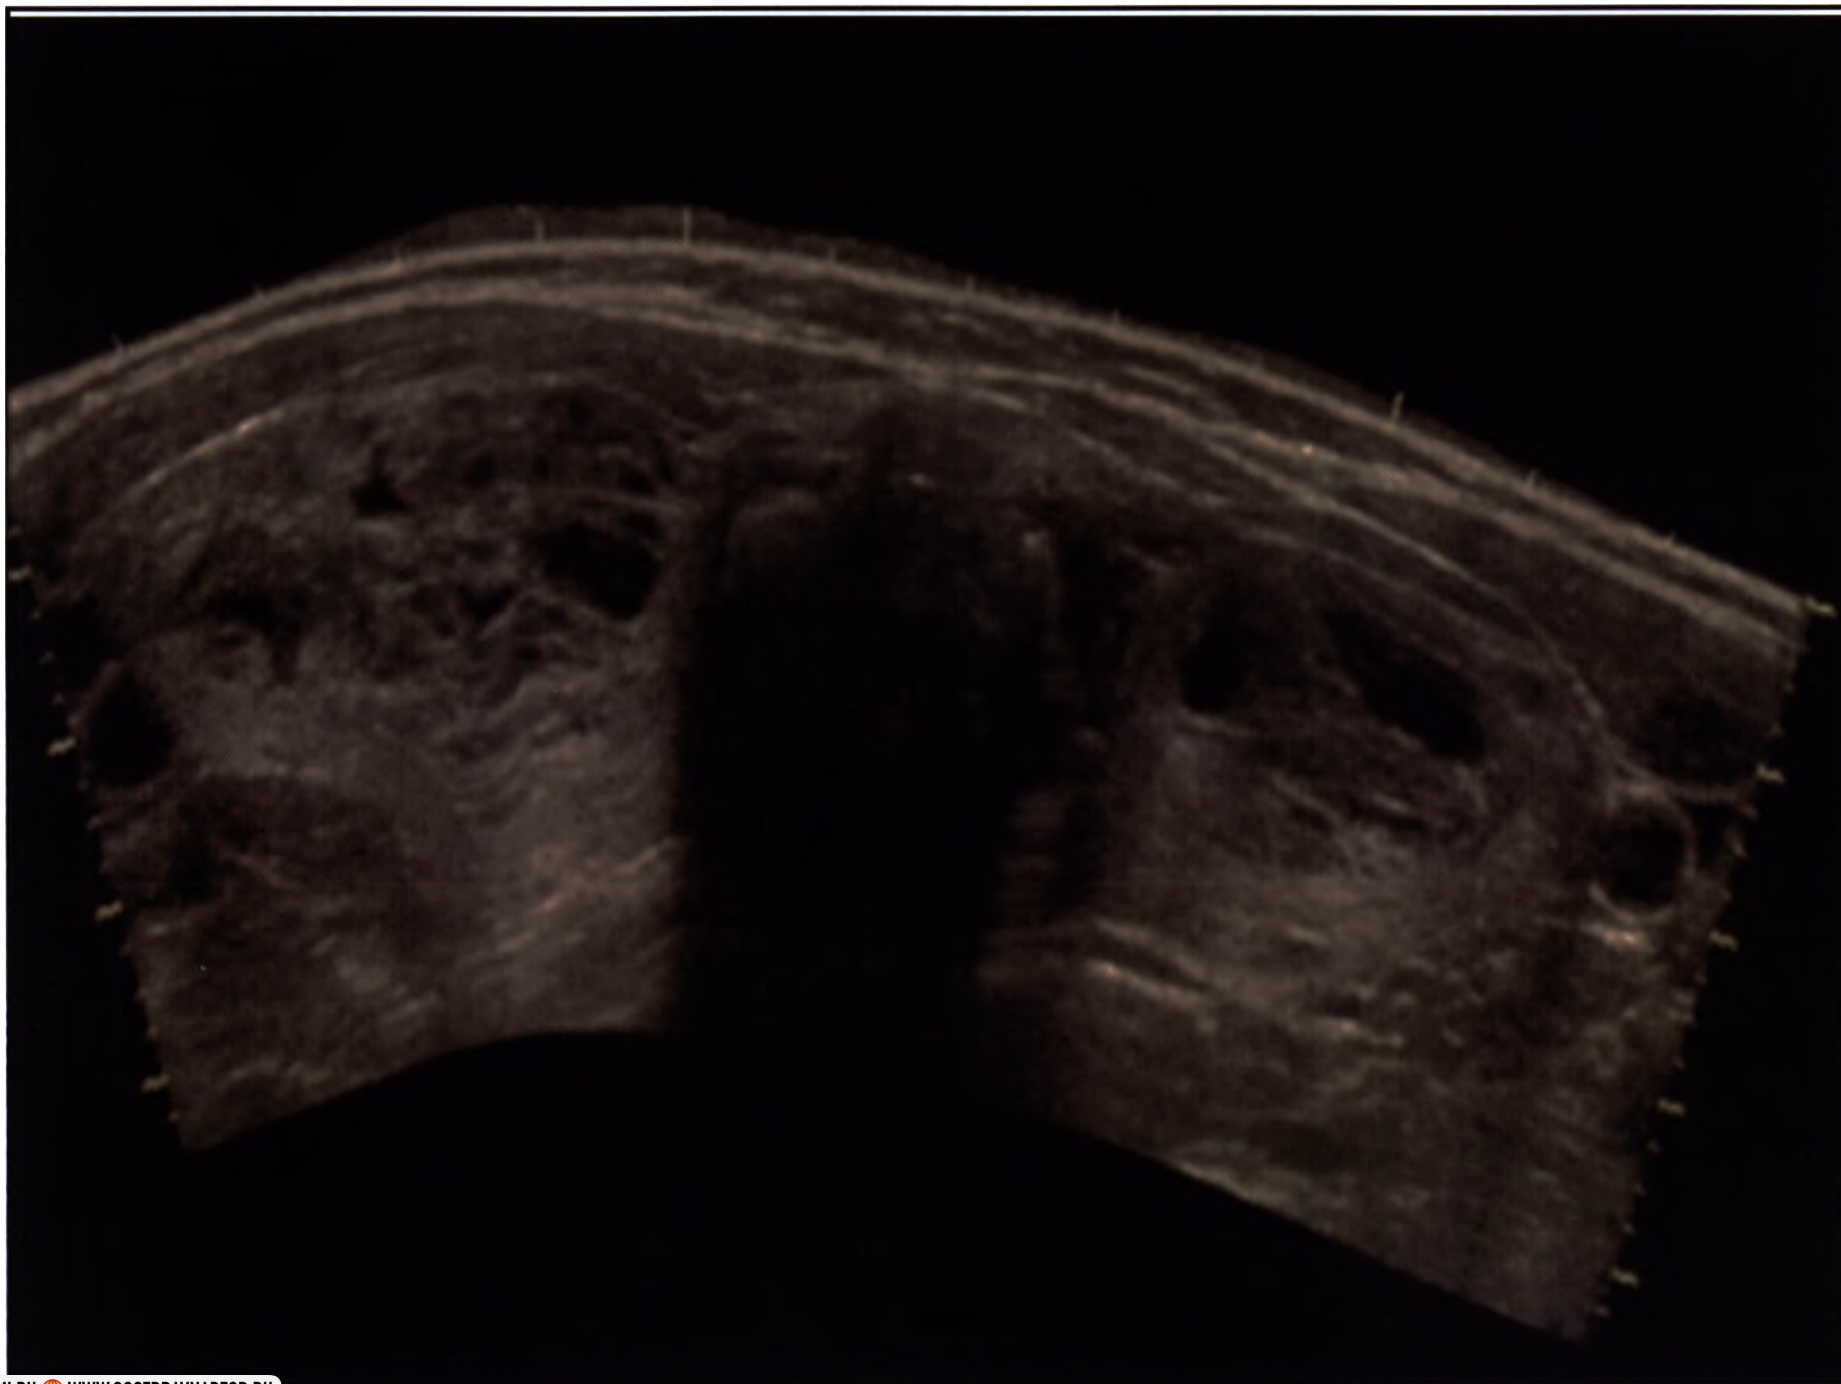



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме М-режима - Anatomical M-Mode.
(Версии: R2, R3, R4)

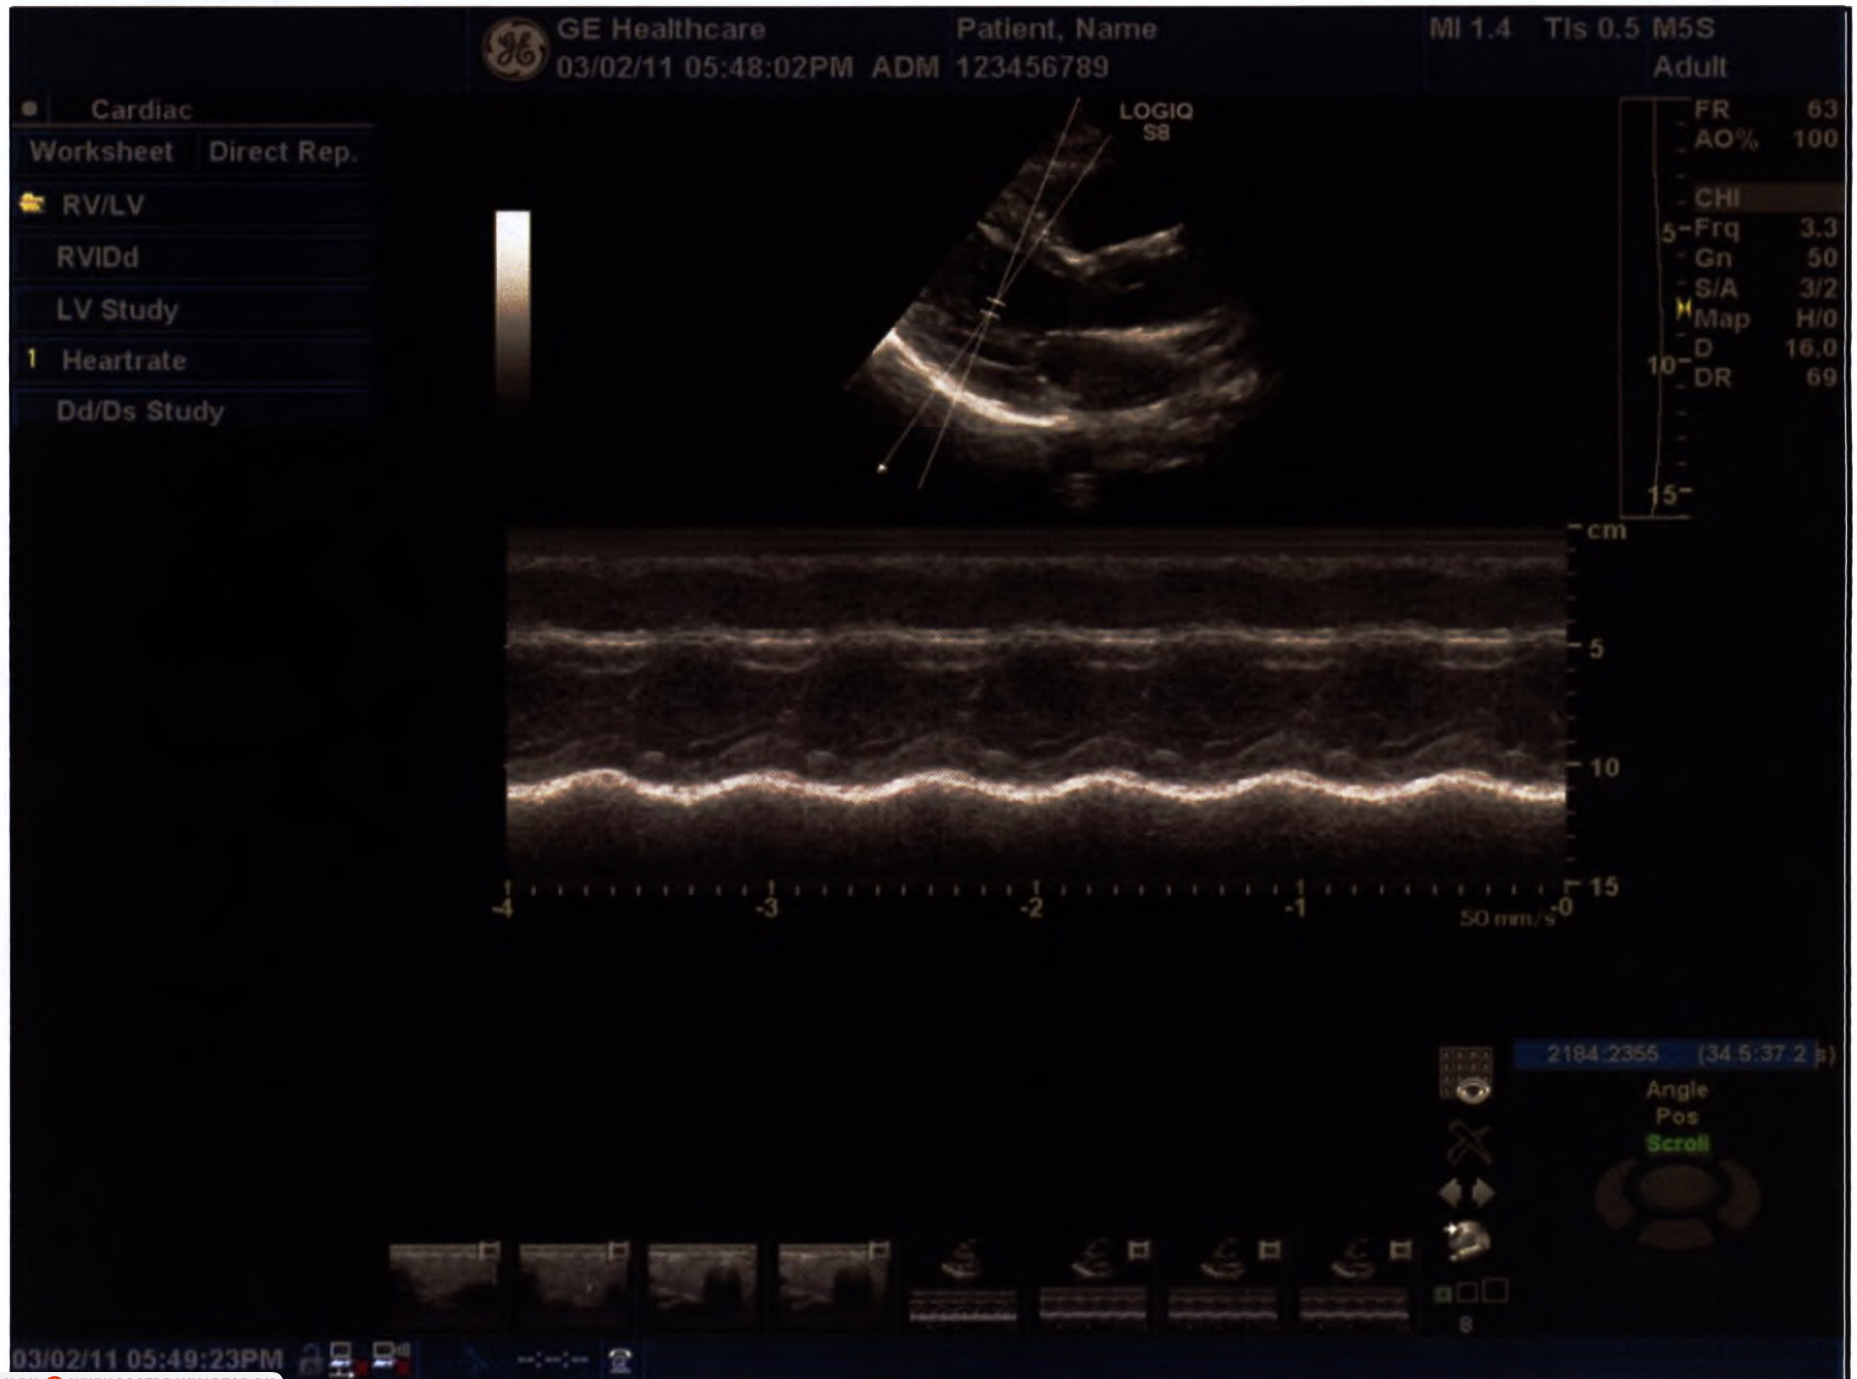

Программное обеспечение, обеспечивающее создание отчетов об исследованиях - Report Writer.(Версии: R2, R3, R4)



GE Medical Systems


Name : GE Test	Patient ID : 123-4567	Date : 07/09/2004
----------------	-----------------------	-------------------

Comments Test exam



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии - Elastography (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



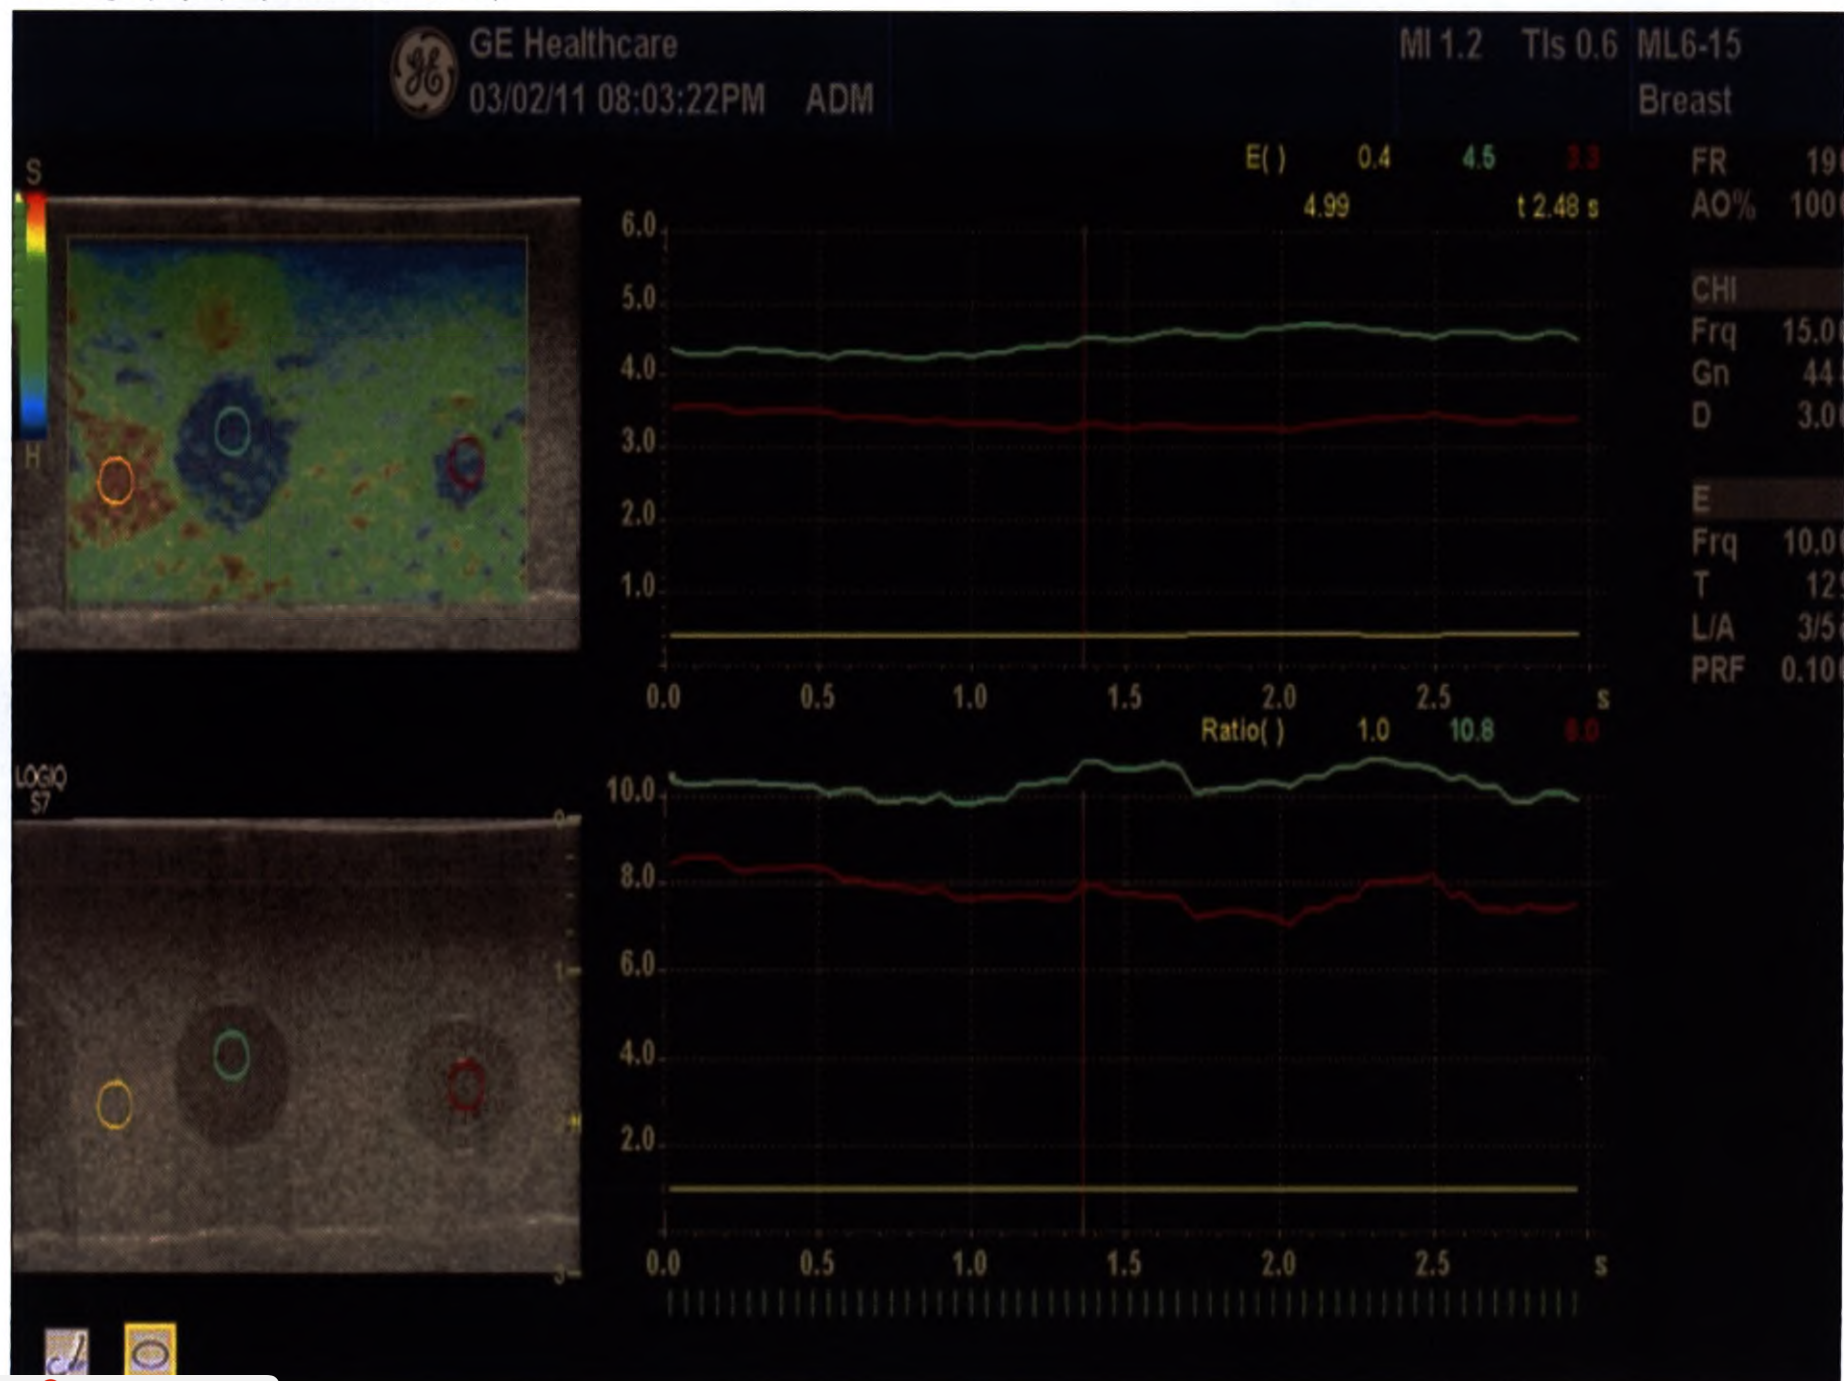

Patient ID: Last Name:

First Name:

Search key: **Exam Description** string:

Patient ID	Last Name	First Name	Last Exam	Copi...	Status Msg	Img. size
------------	-----------	------------	-----------	---------	------------	-----------


Task: ☒ Import
☐ Export
☐ Worklist
☐ Q/R
☐ MPEGVue

From:


To:


Selected Data 0.0 / 1027.9 MB Show: ☒ All ☐ - / -

Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо - Echo Stress.
(Версии: R2, R3, R4)

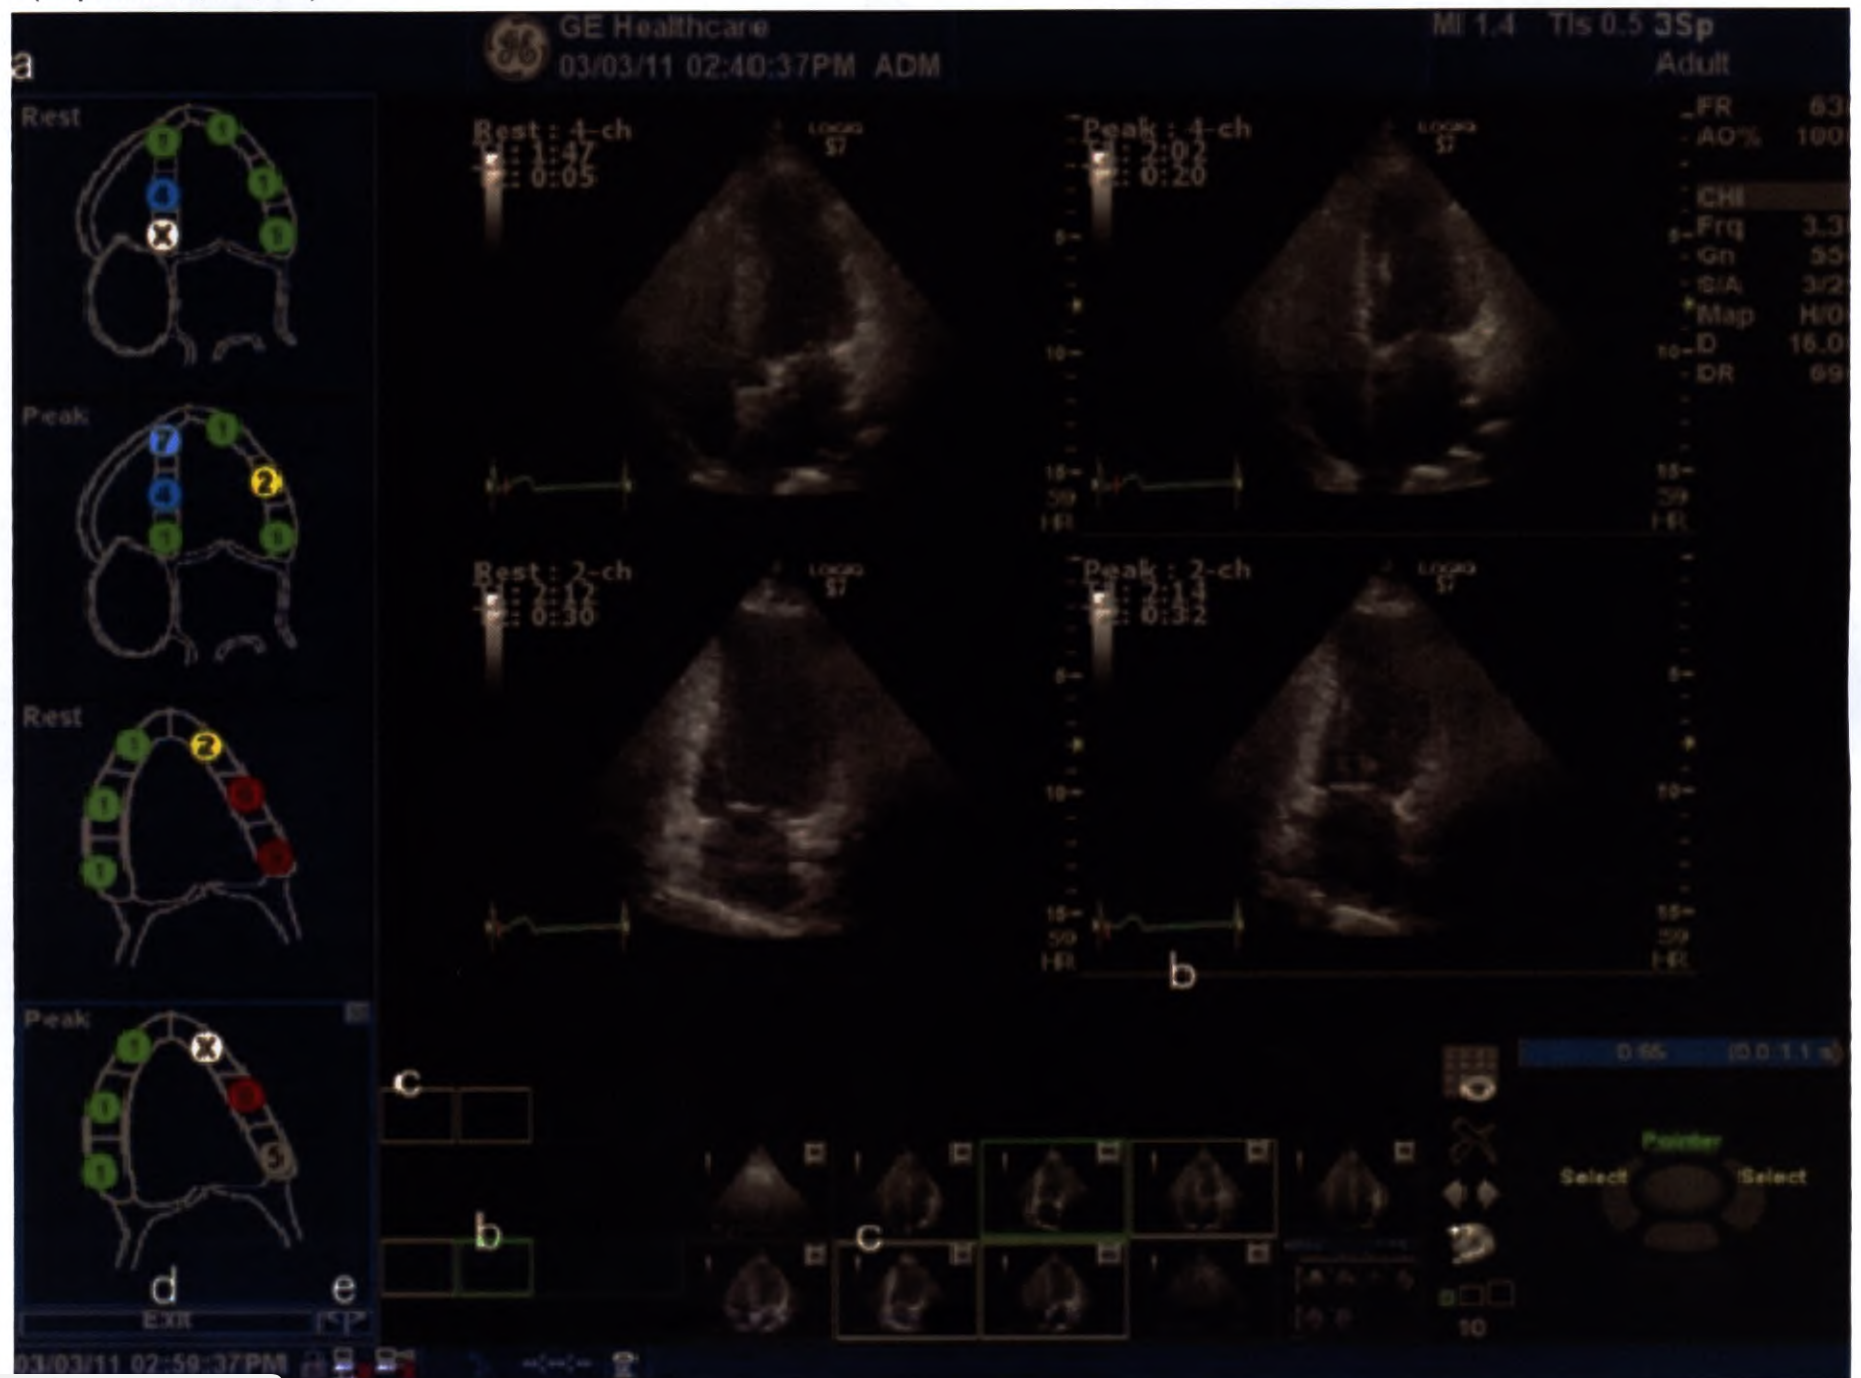

Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме тканевого доплера - TVI (Tissue Velocity Imaging). (Версии: R2, R3, R4)

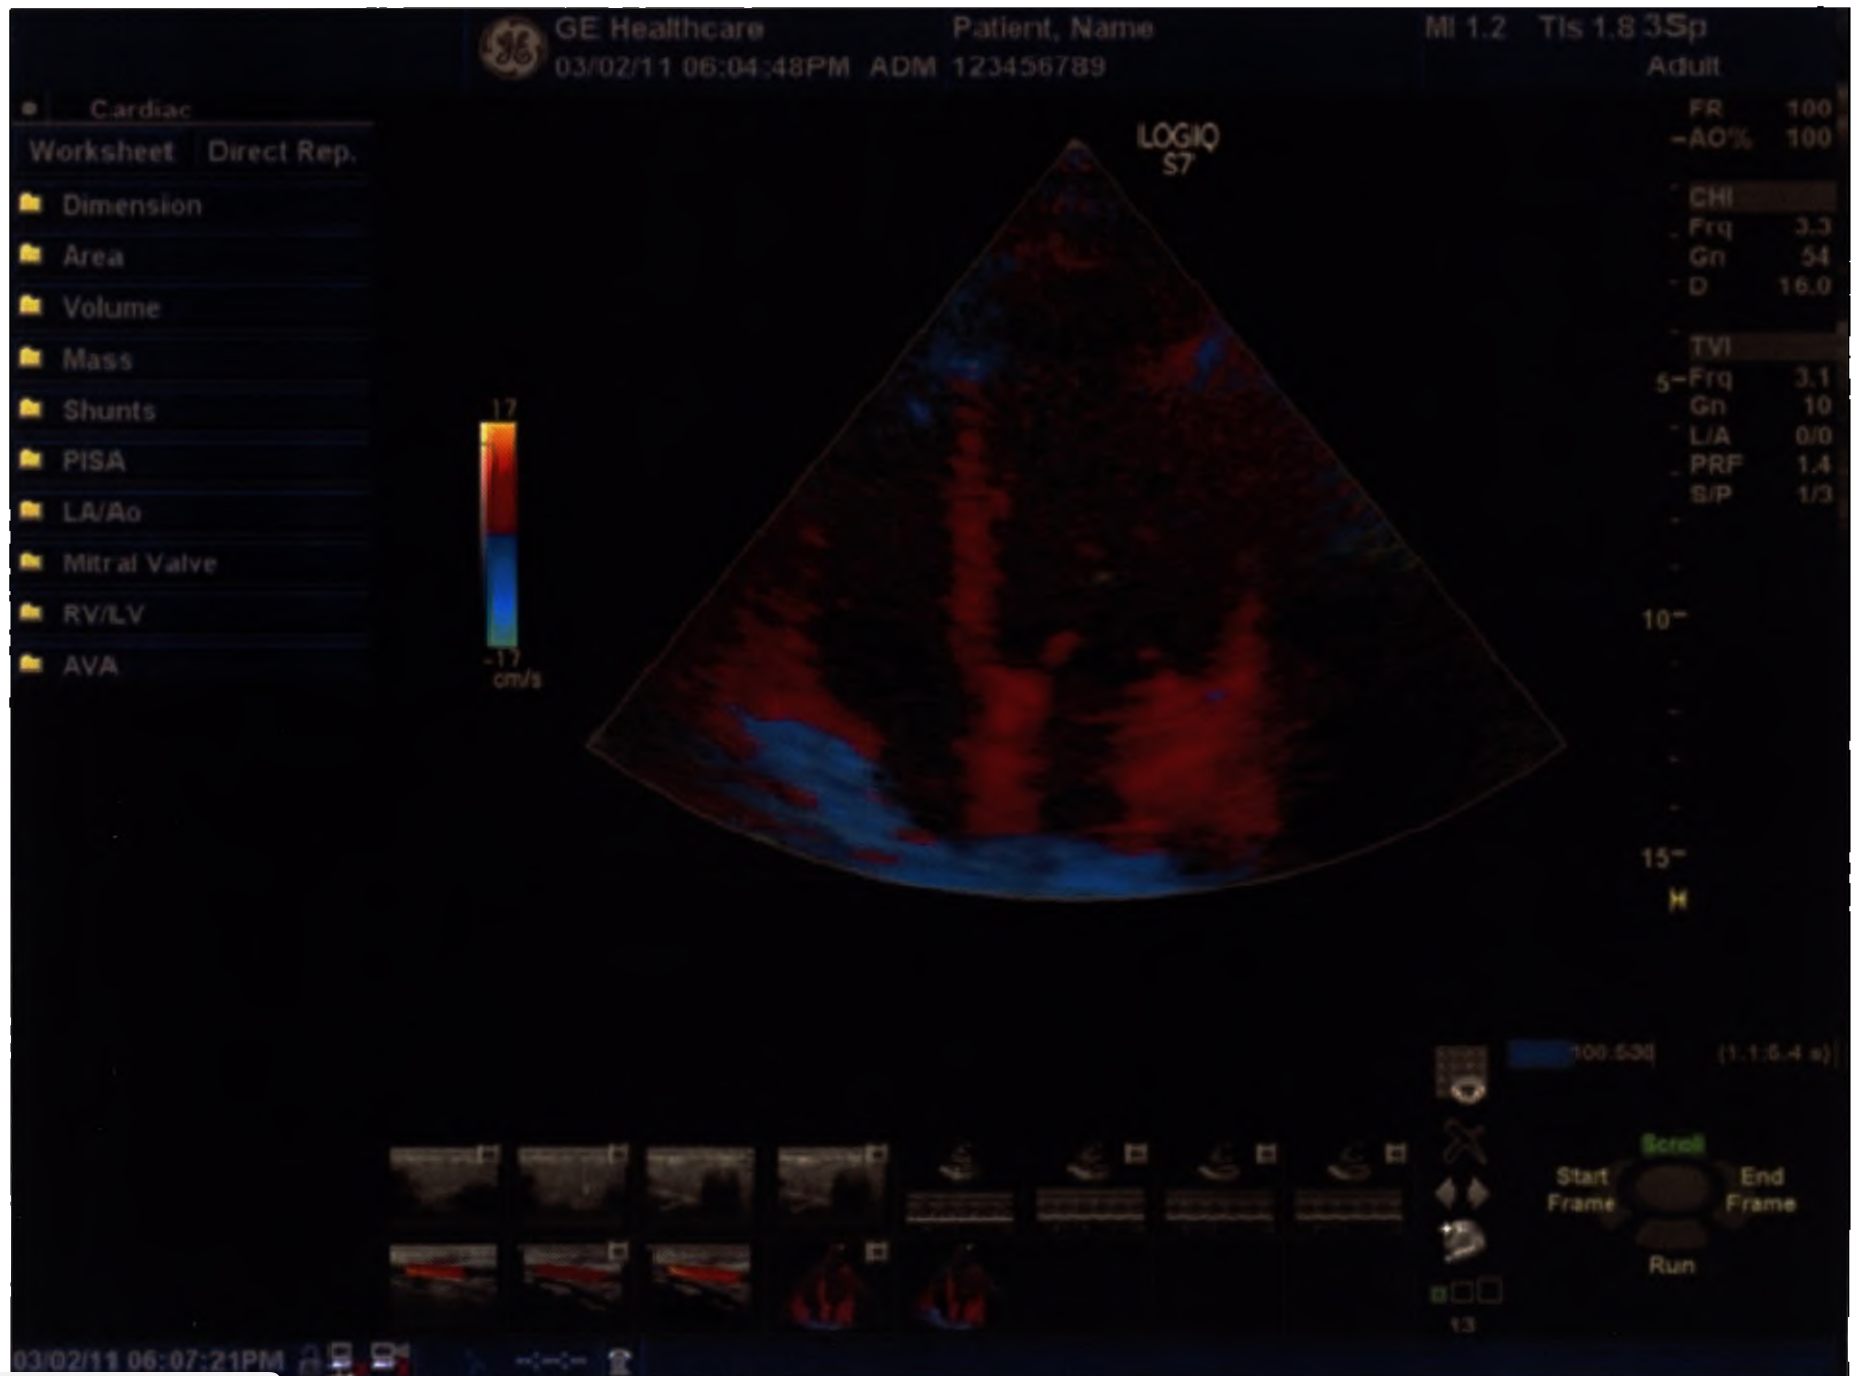


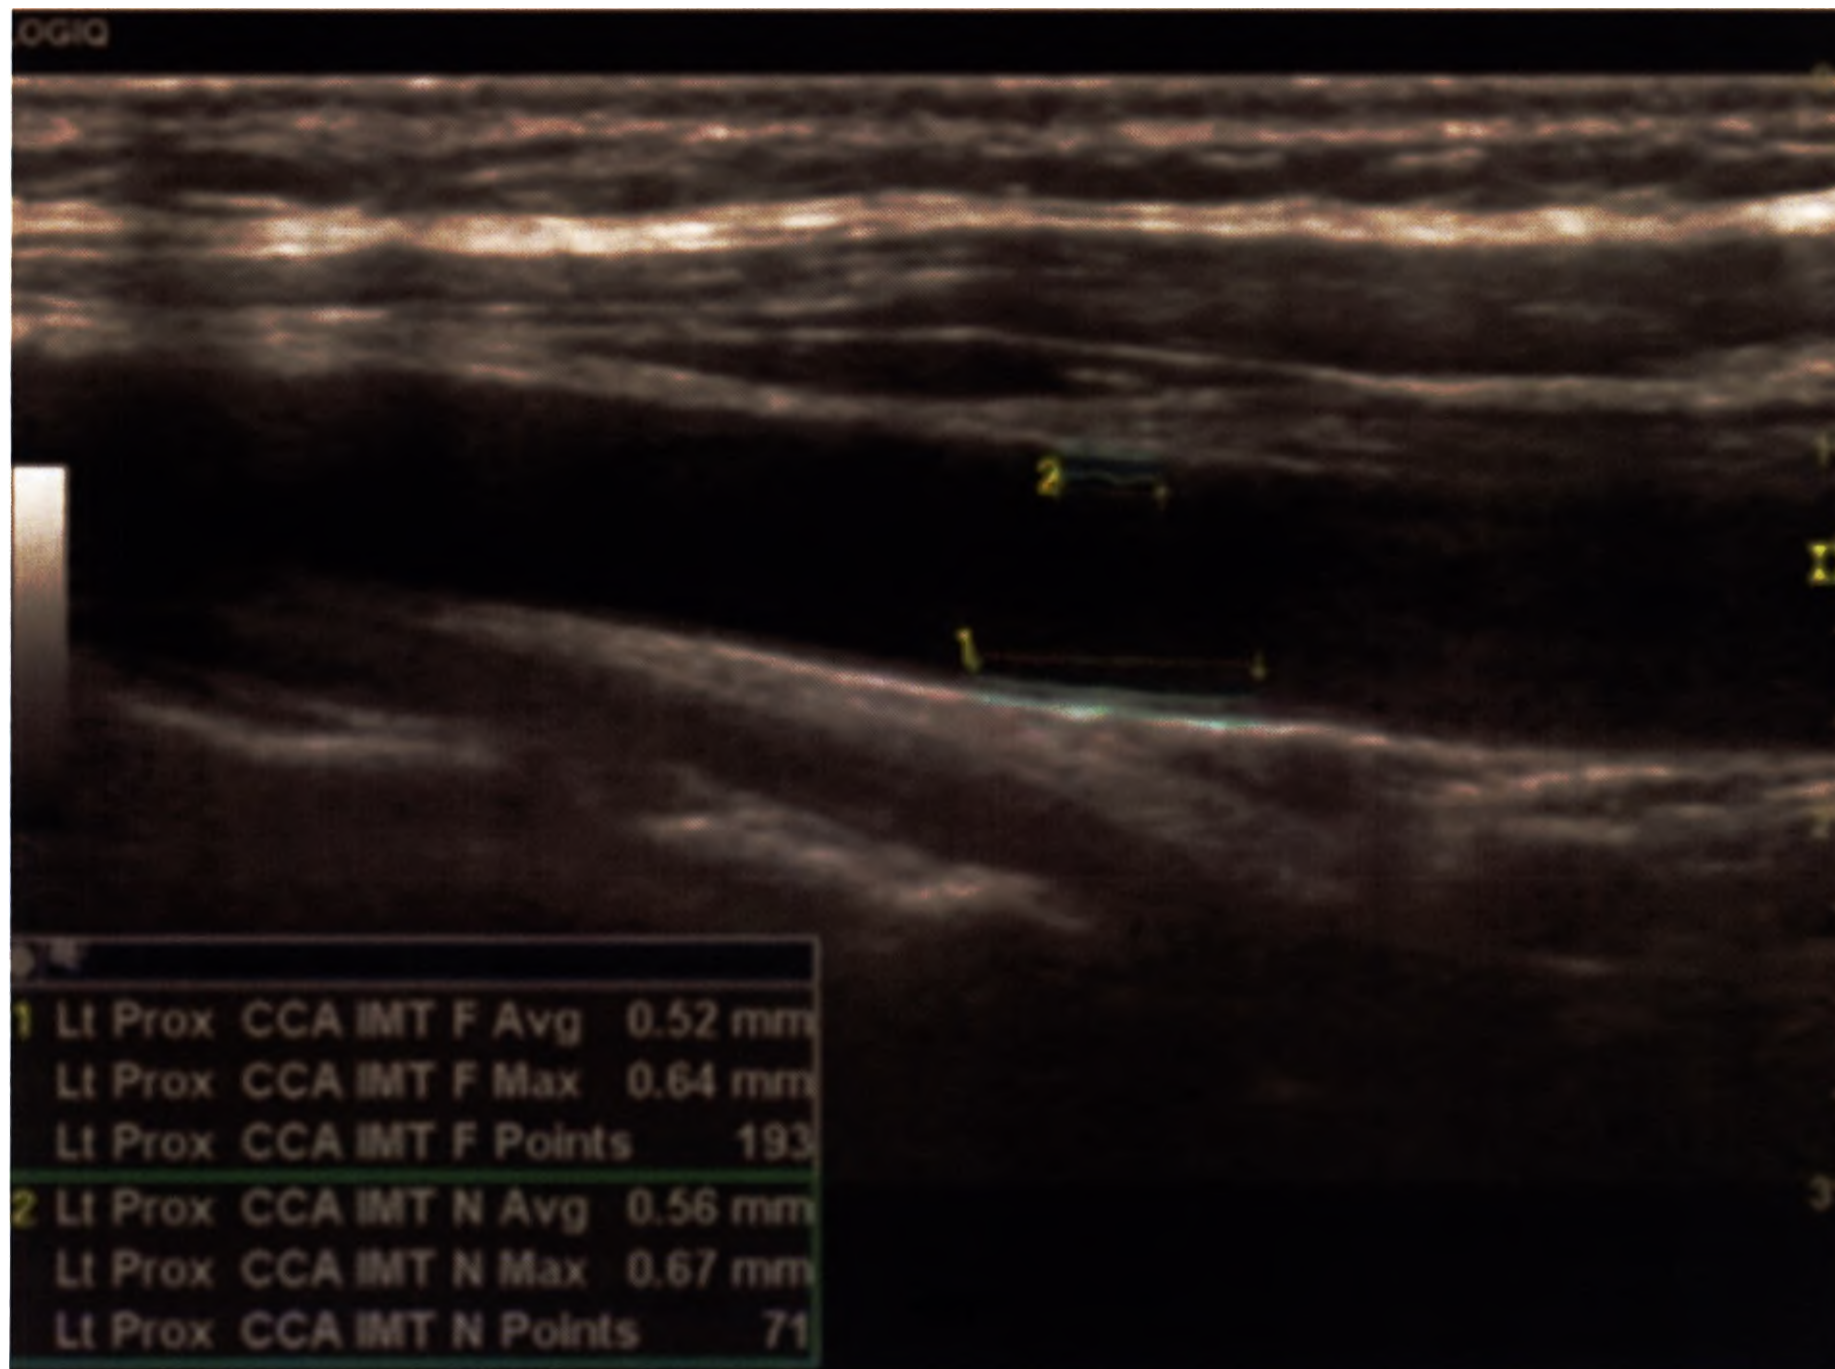

Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера - CW Doppler. (Версии: R2, R3, R4)




Устройство для расширения памяти аппарата. (Версии: R2, R3, R4)

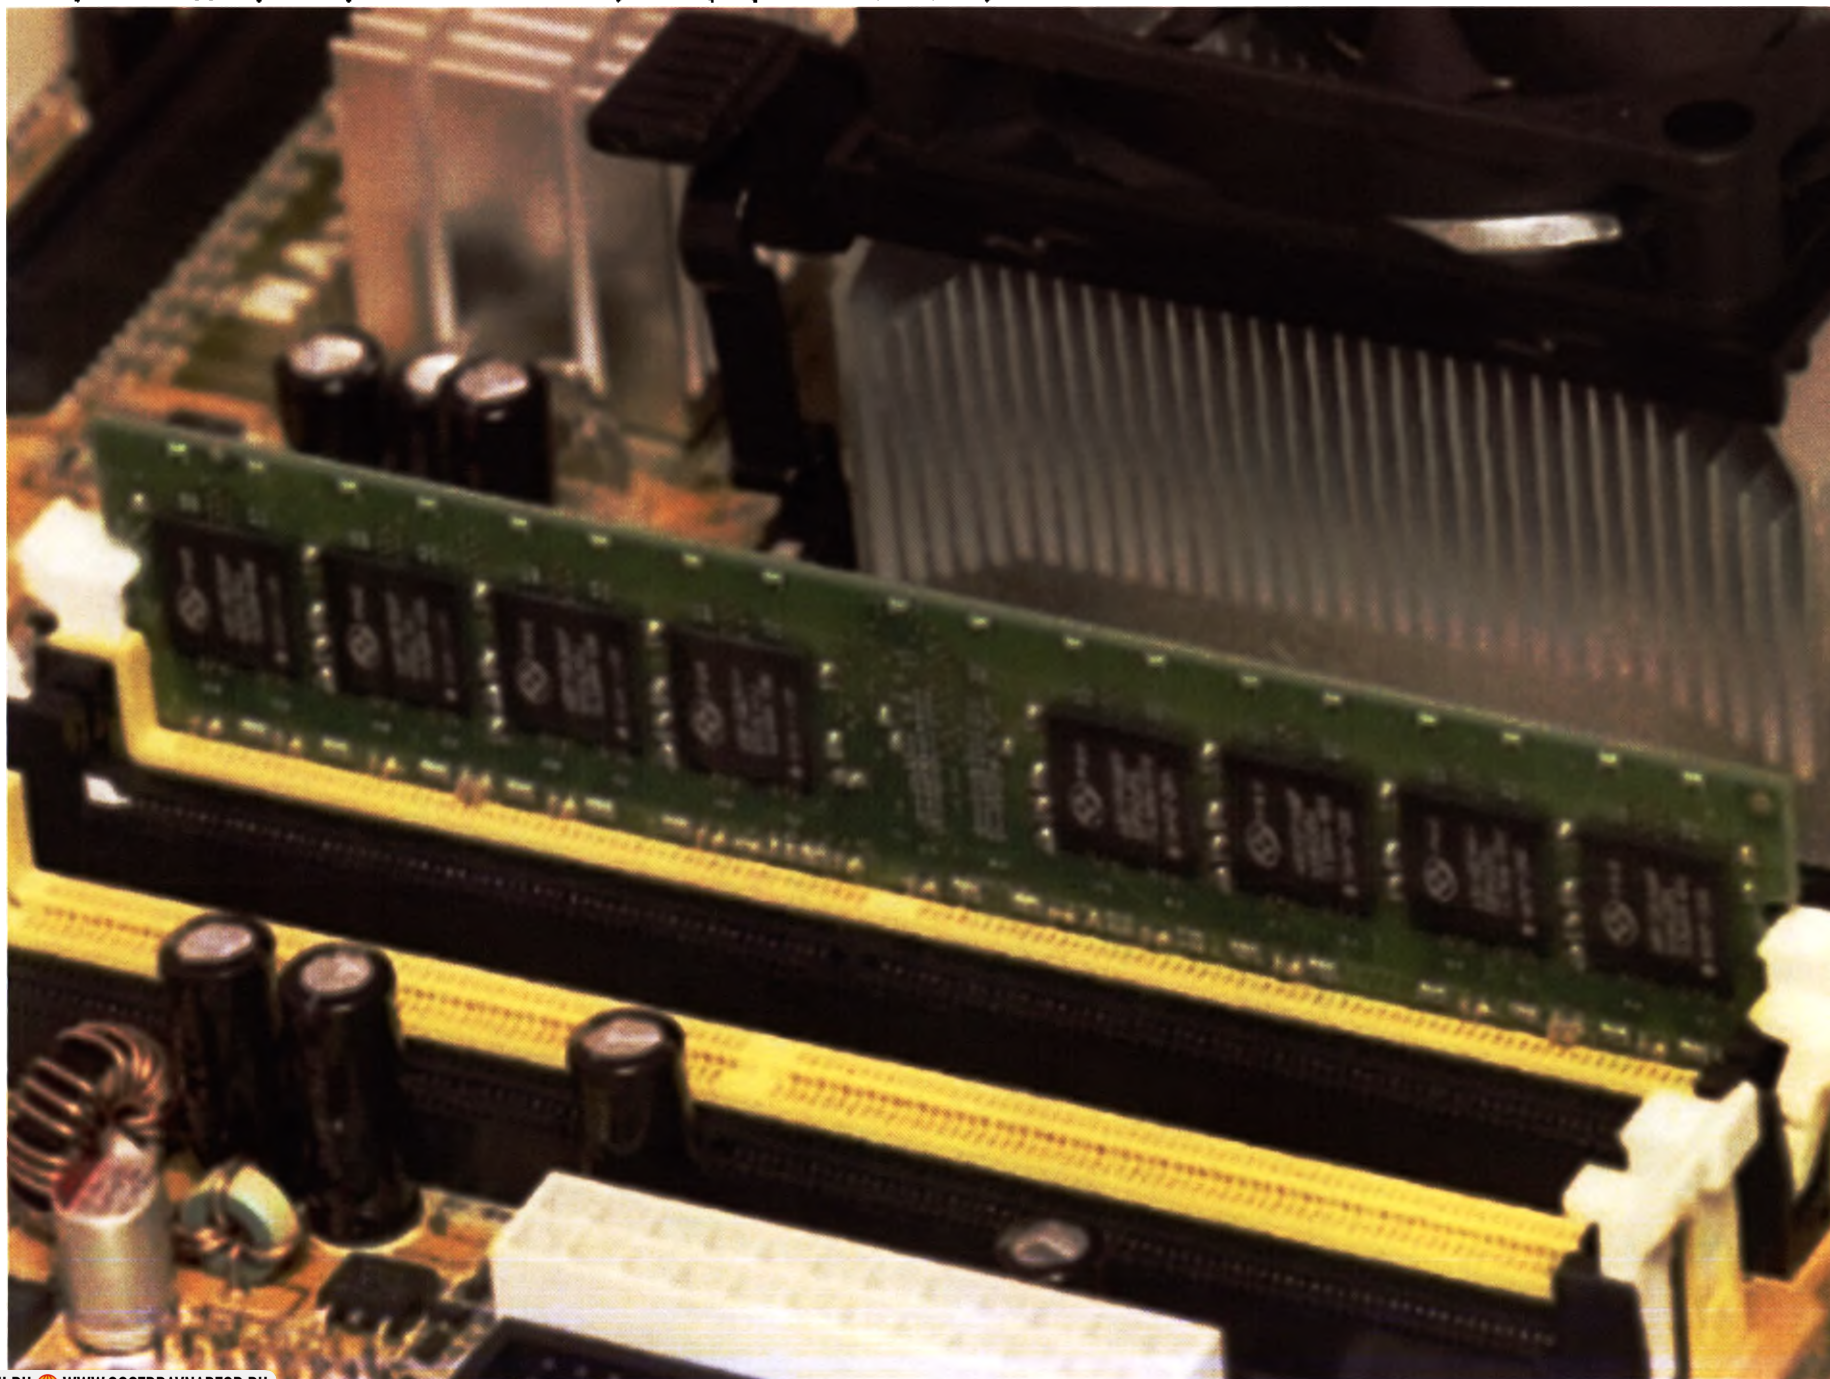


Программы оптимизации и обработки медицинских ультразвуковых изображений (не более 15 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Ножной переключатель (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

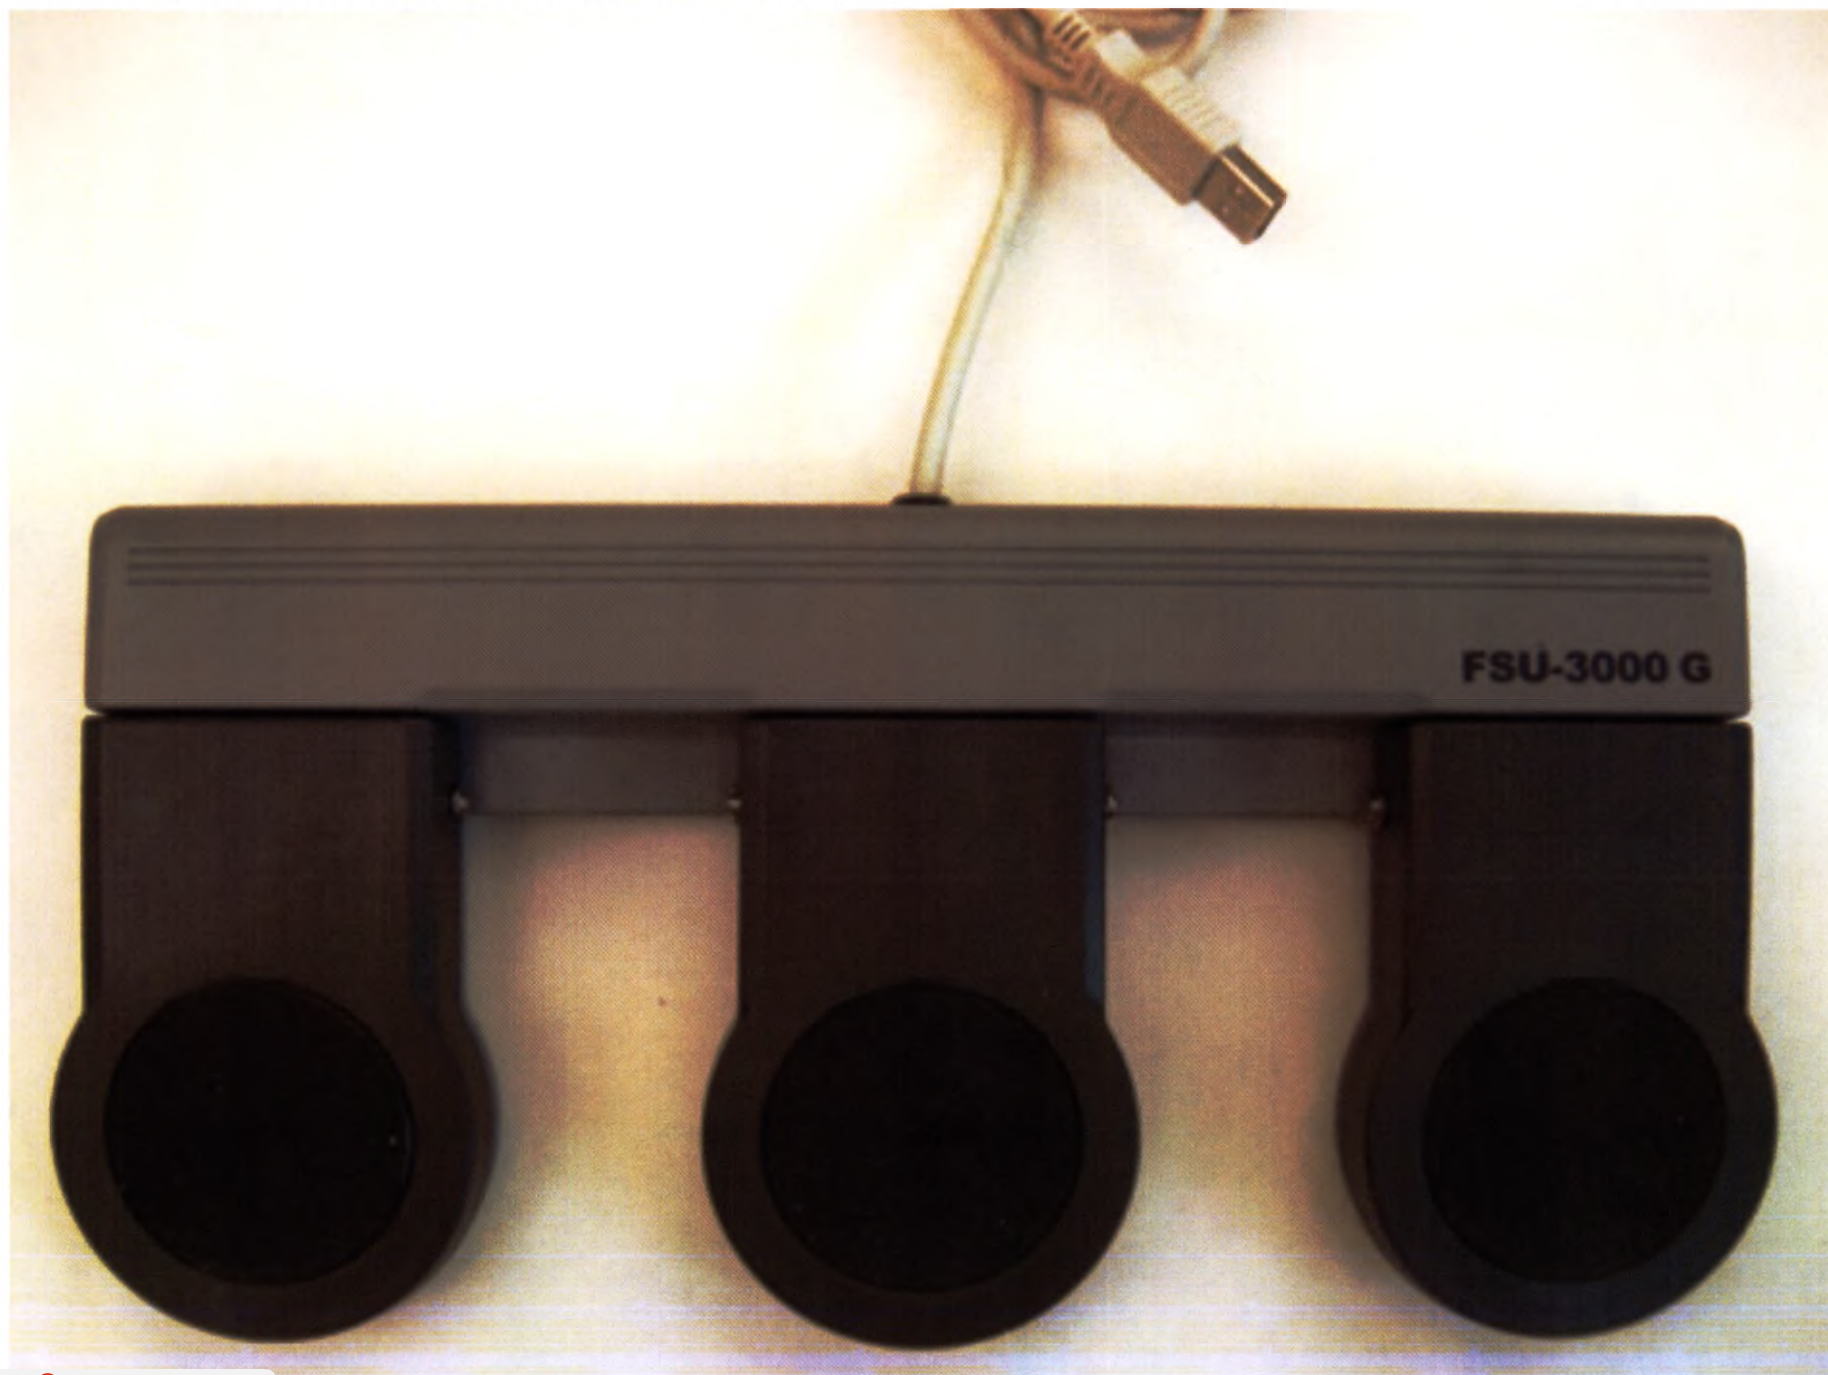


Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов. (Версии: R2, R3, R4)

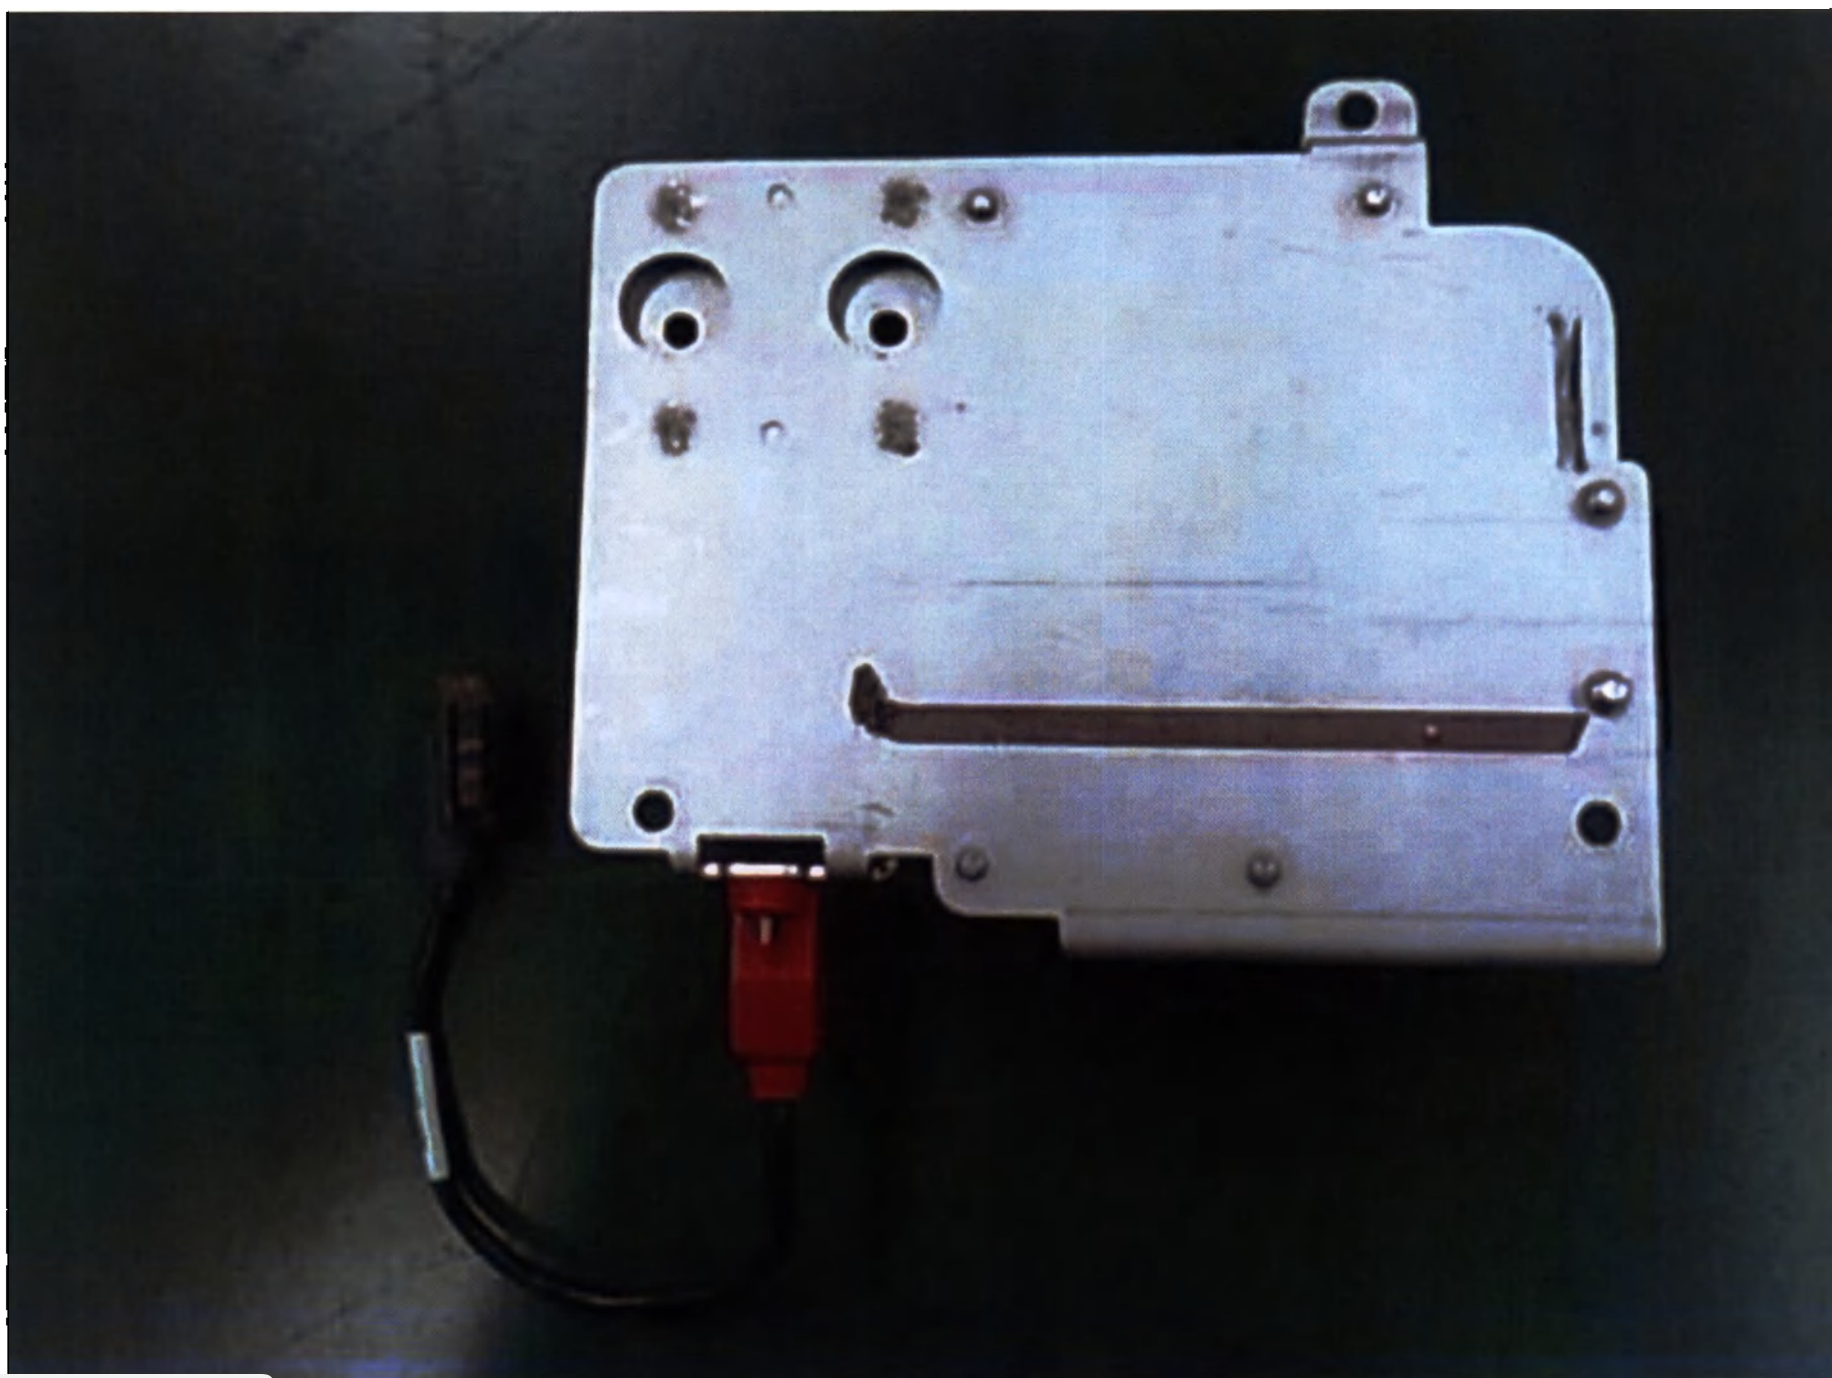


Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов. (Версии: R2, R3, R4)

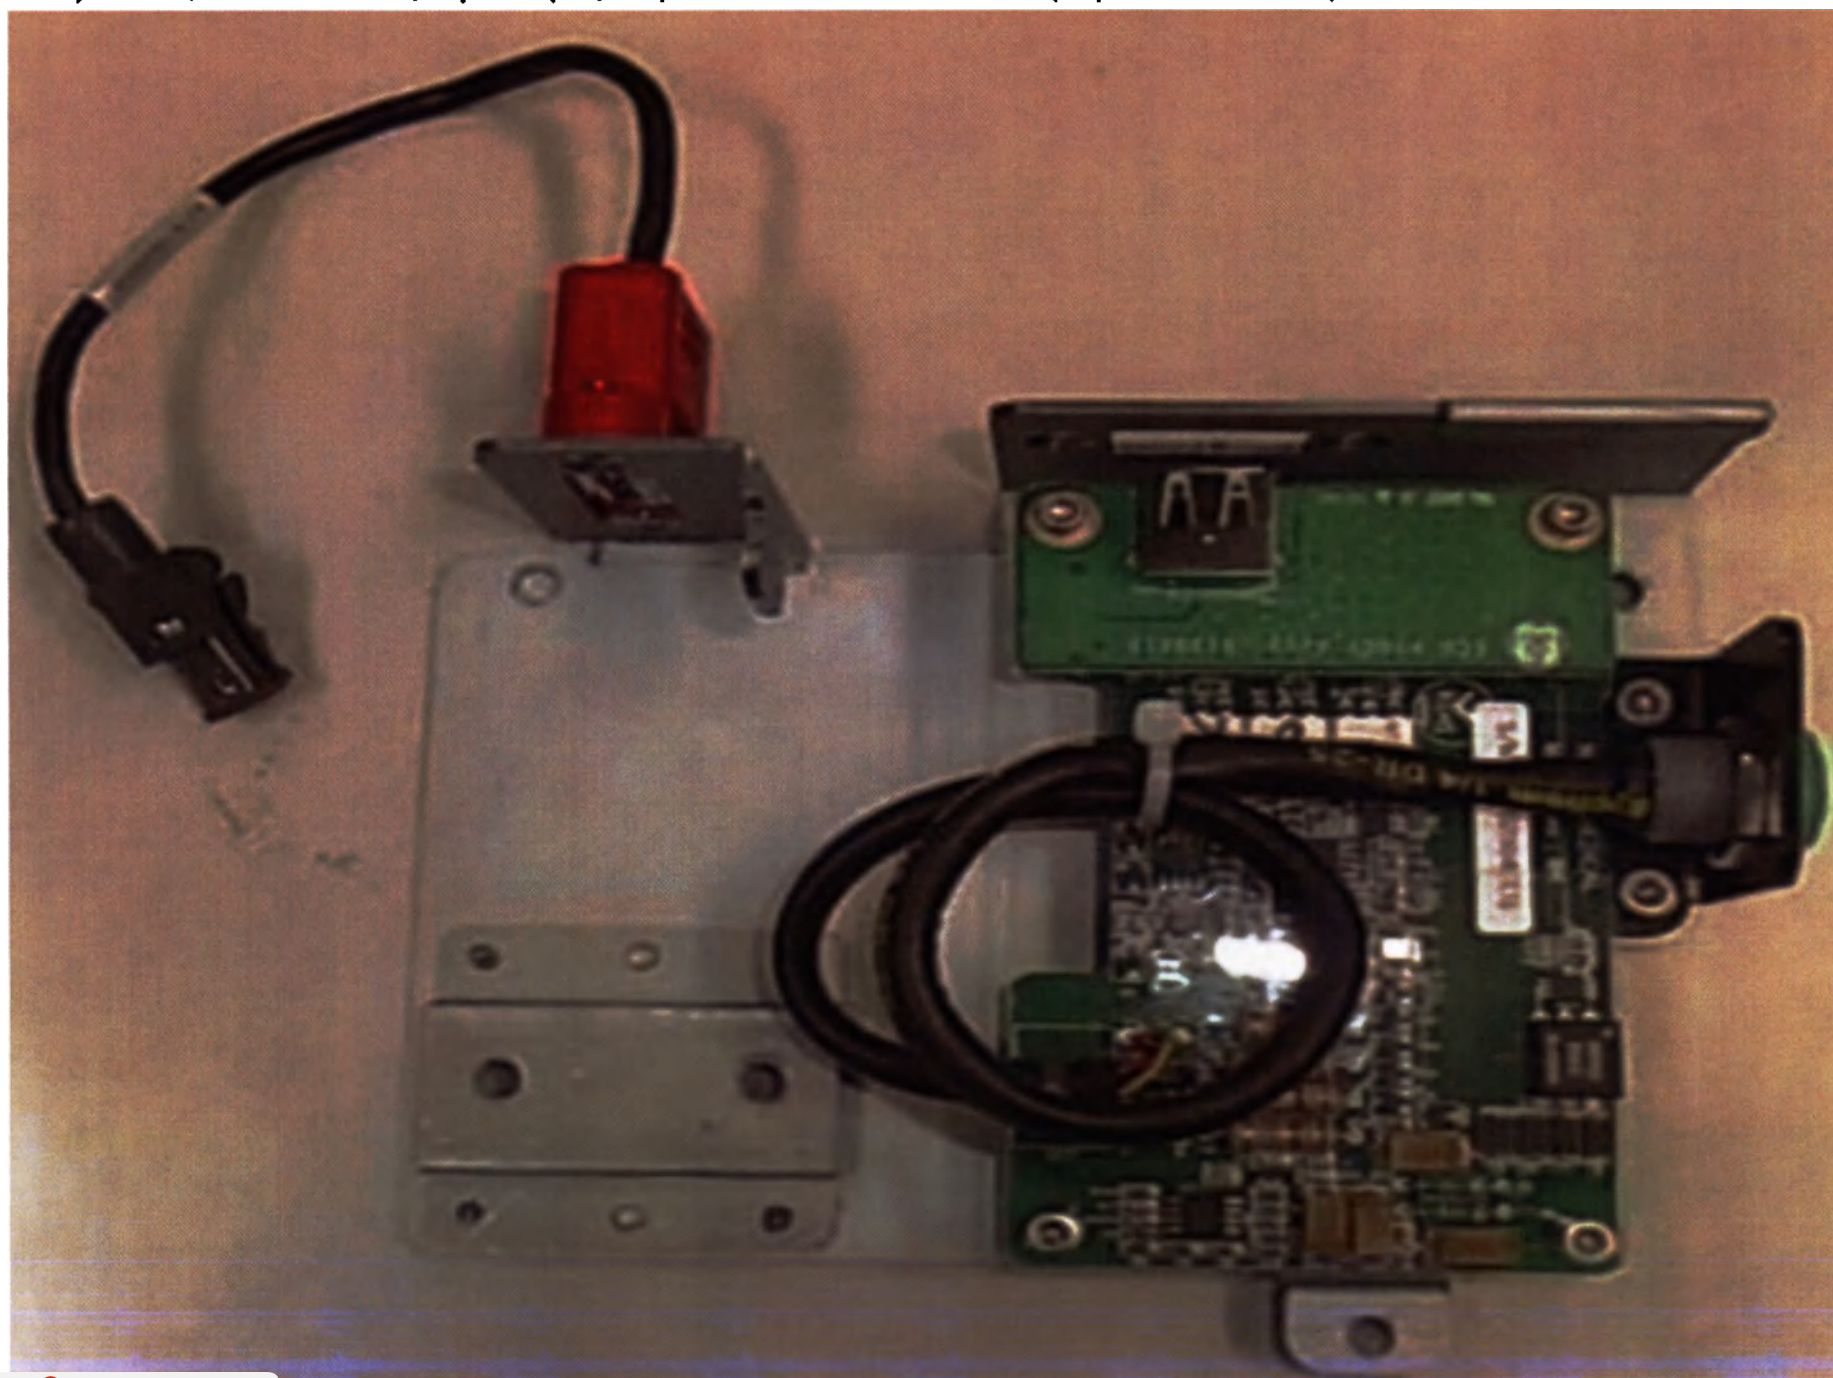


Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов. (Версии: R2, R3, R4)

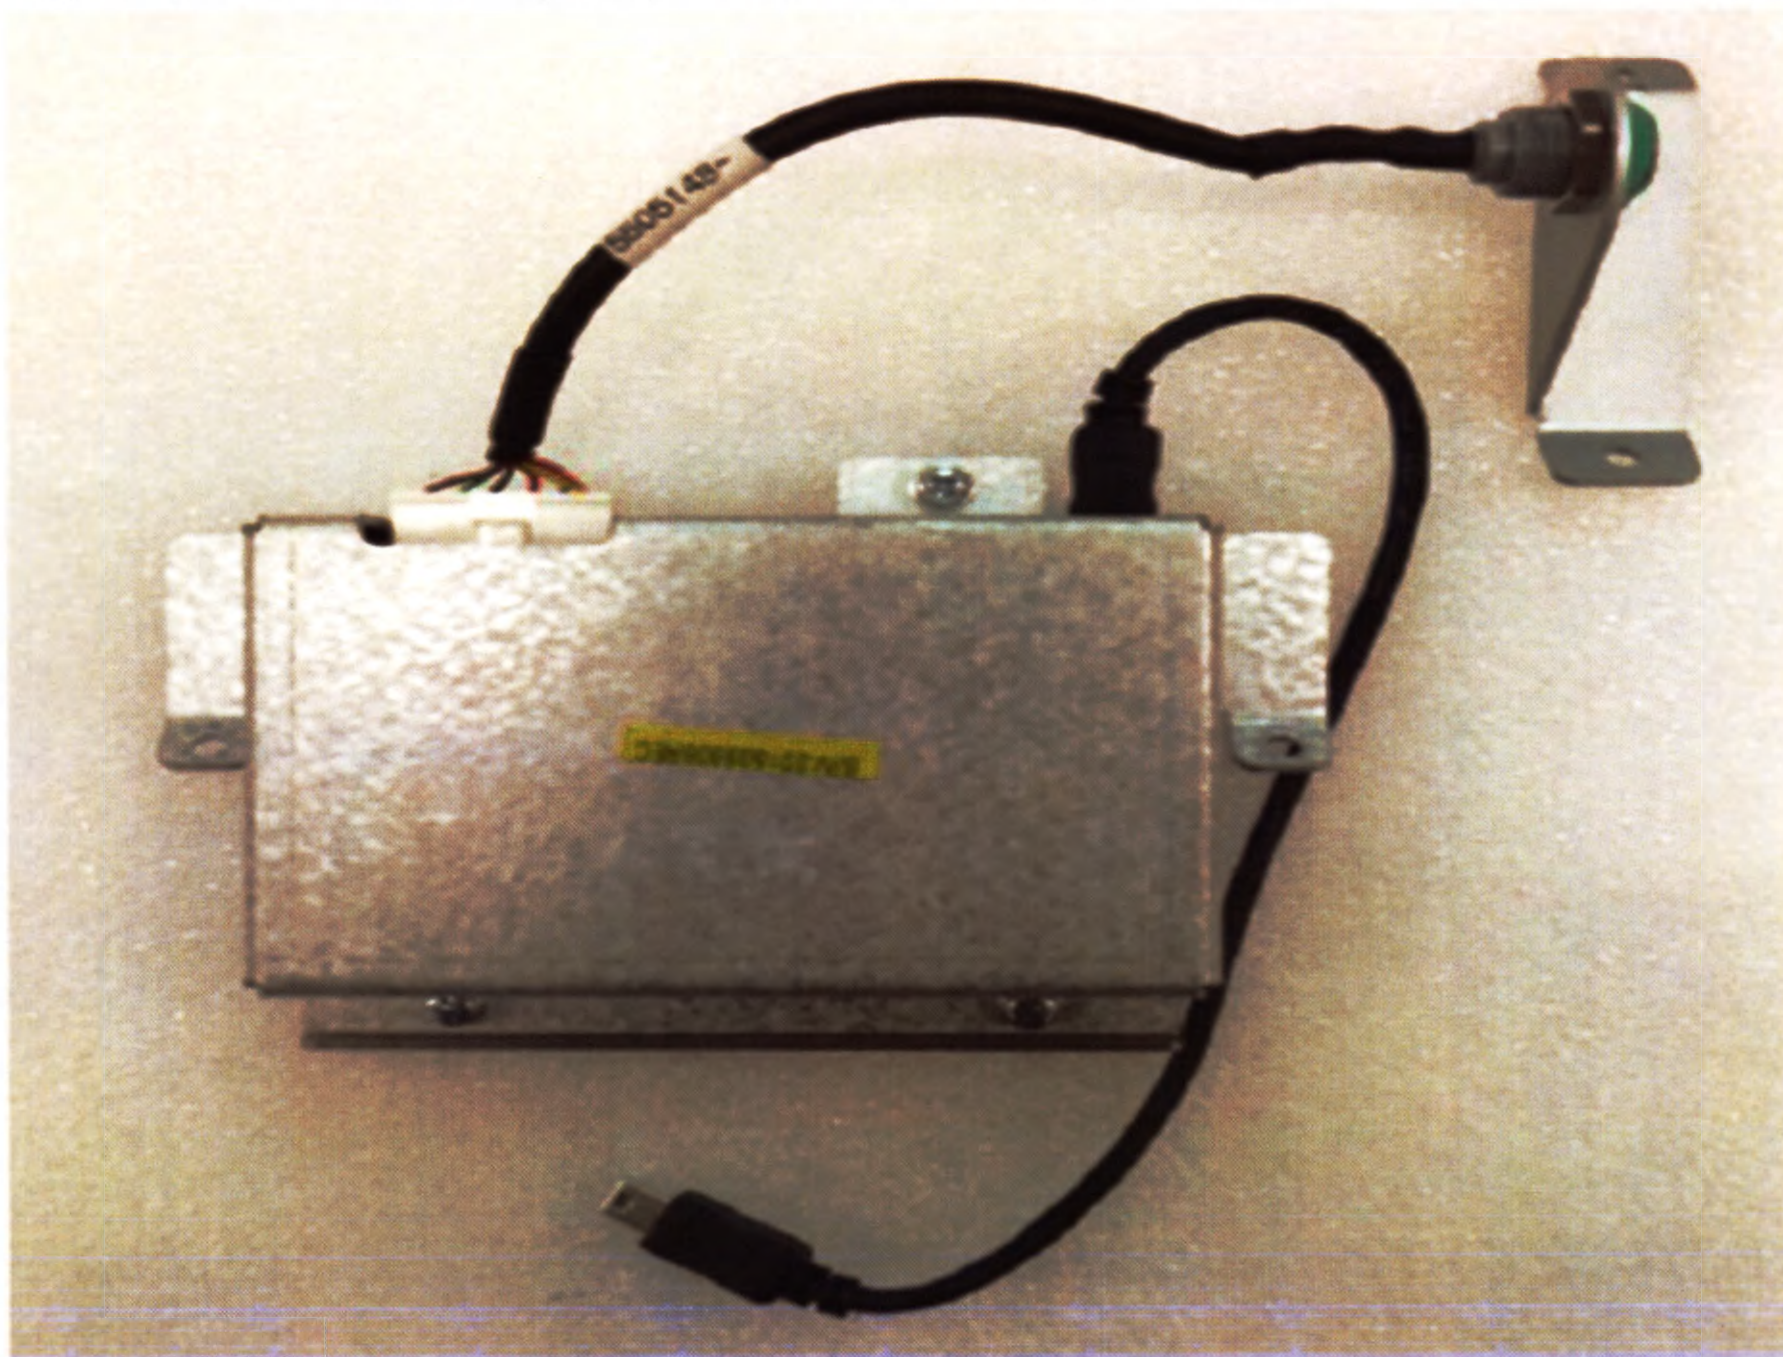

Кабели для устройства, обеспечивающего регистрацию физиологических сигналов (не более 100 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

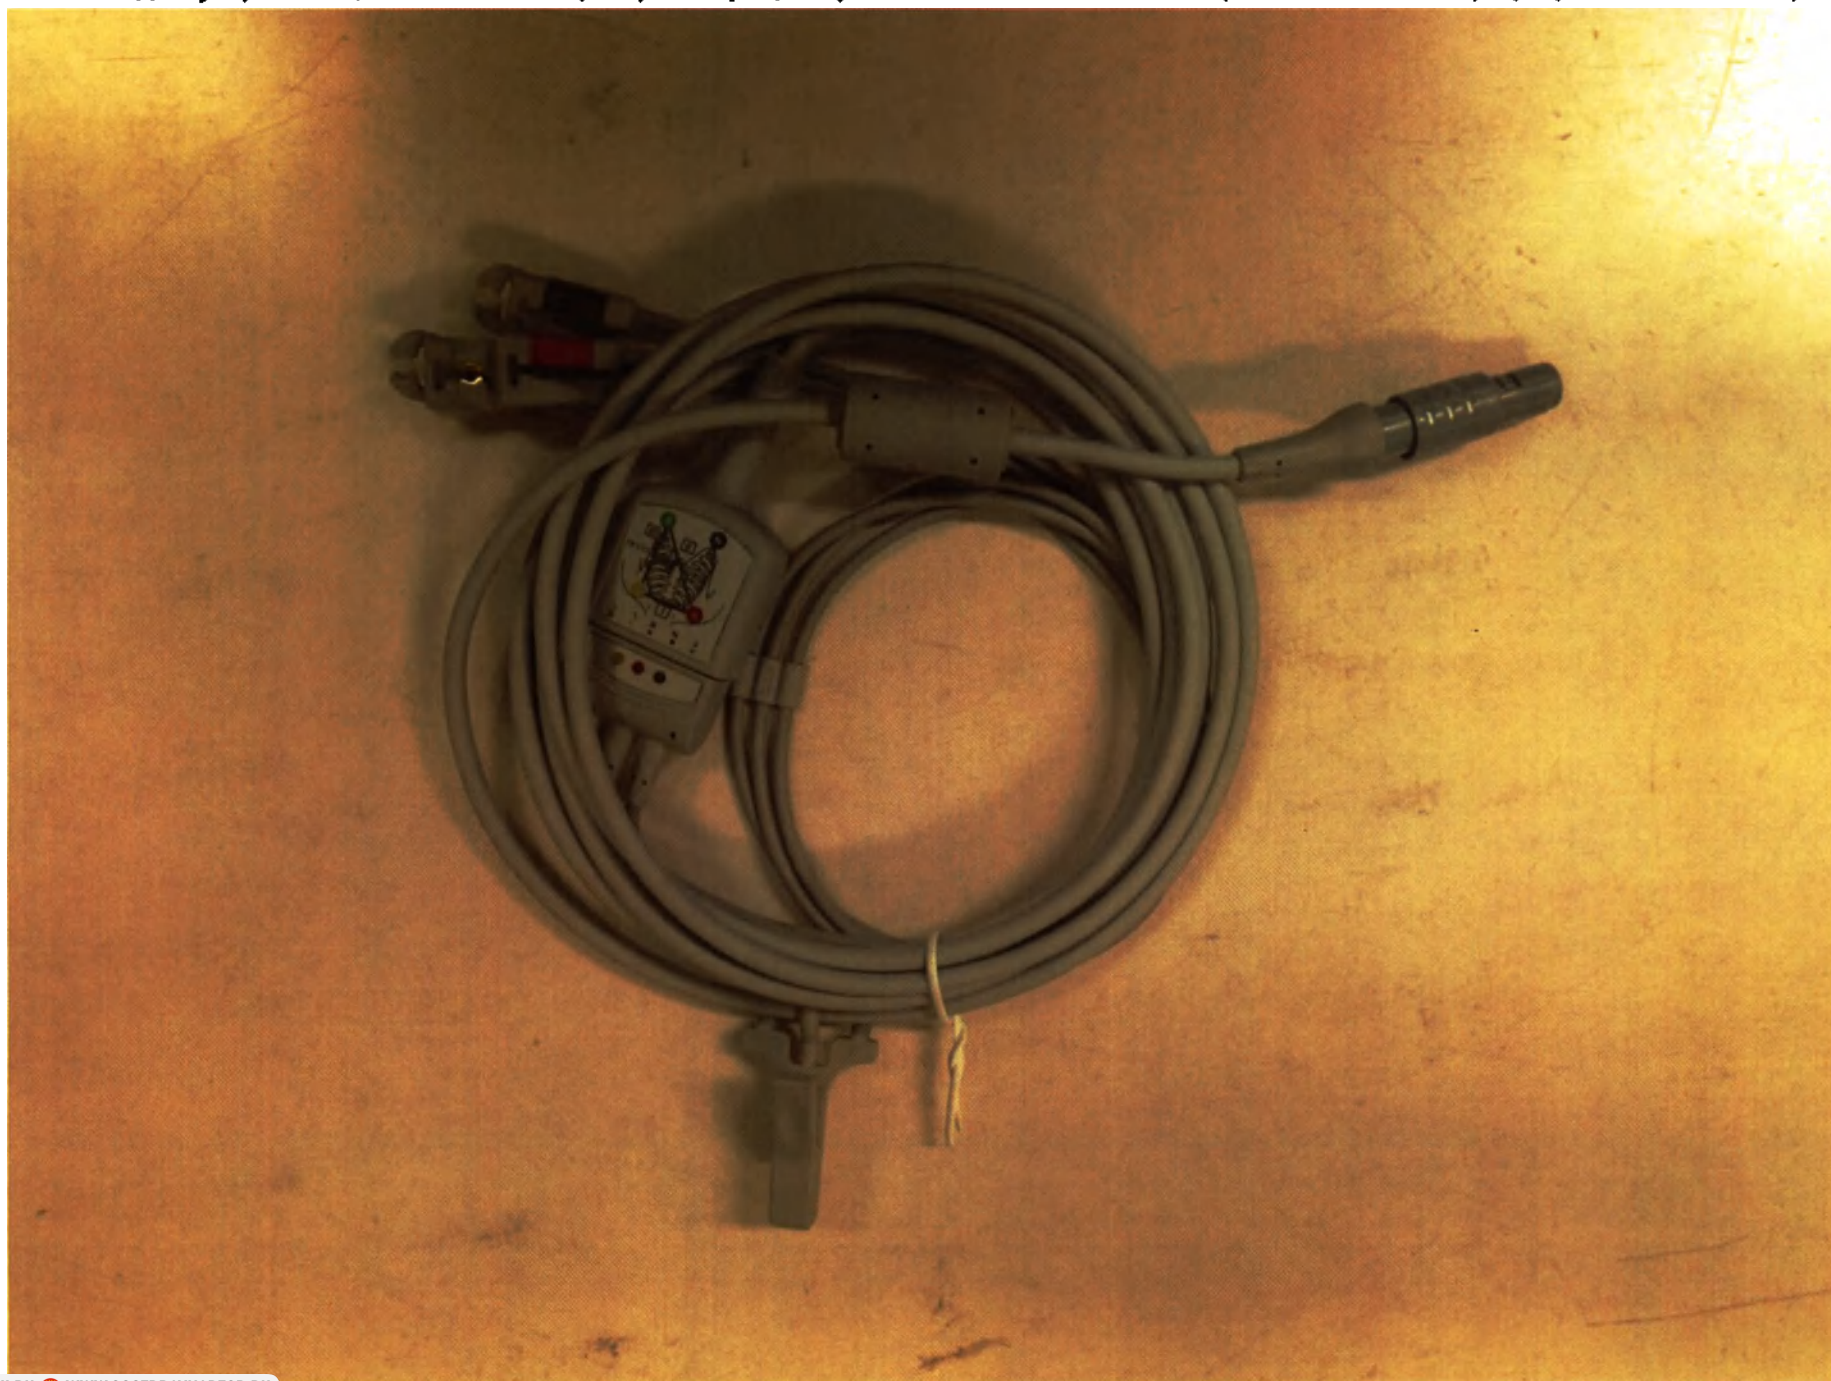


Устройство для крепежа монитора. (Версии: R2, R3, R4)

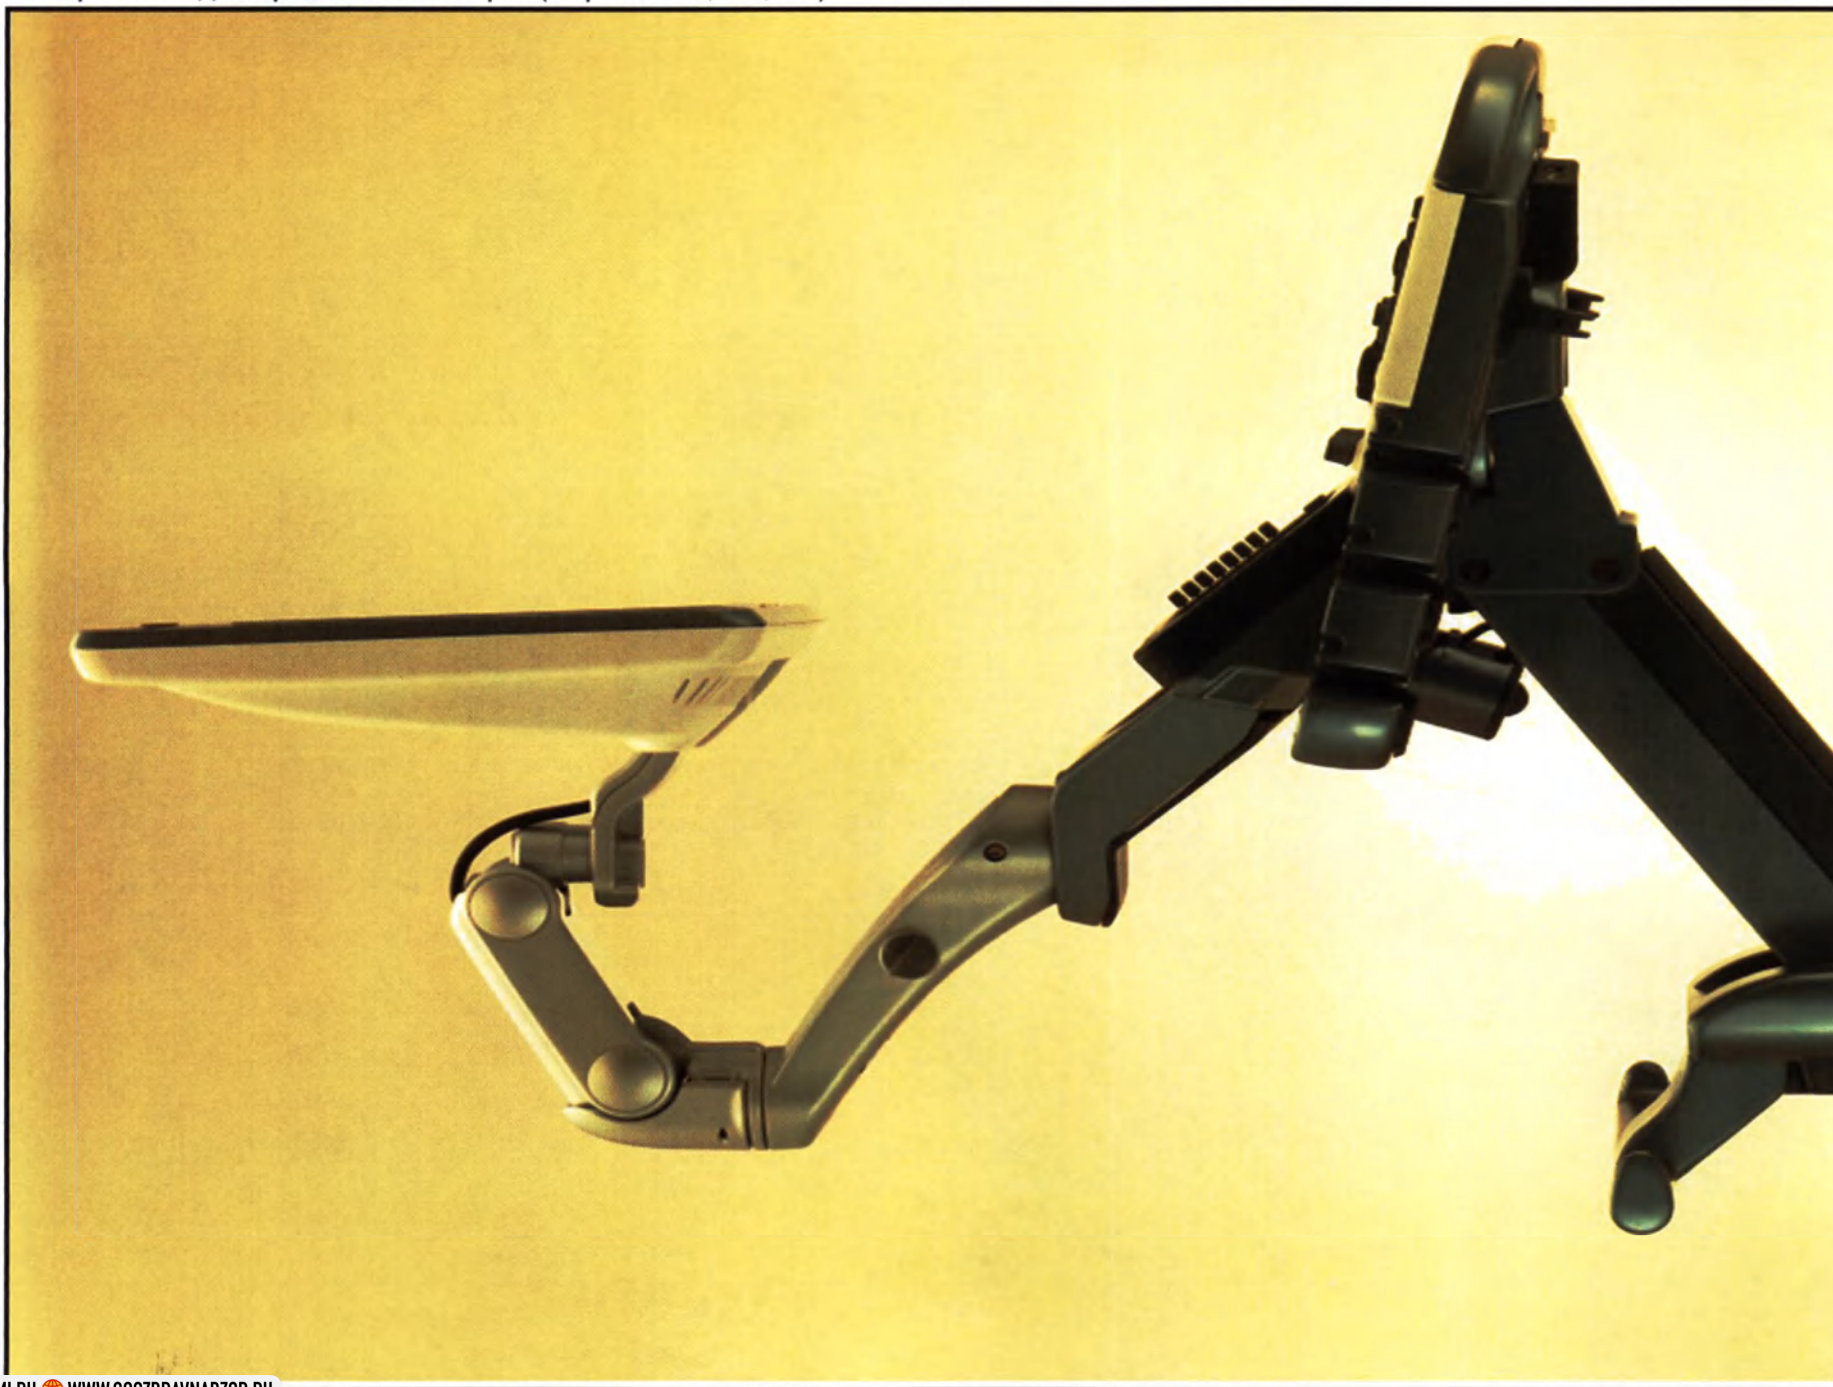

Устройство для крепежа монитора. (Версии: R2, R3, R4)



Устройство для записи ультразвуковых изображений на карту памяти. (Версии: R2, R3, R4)

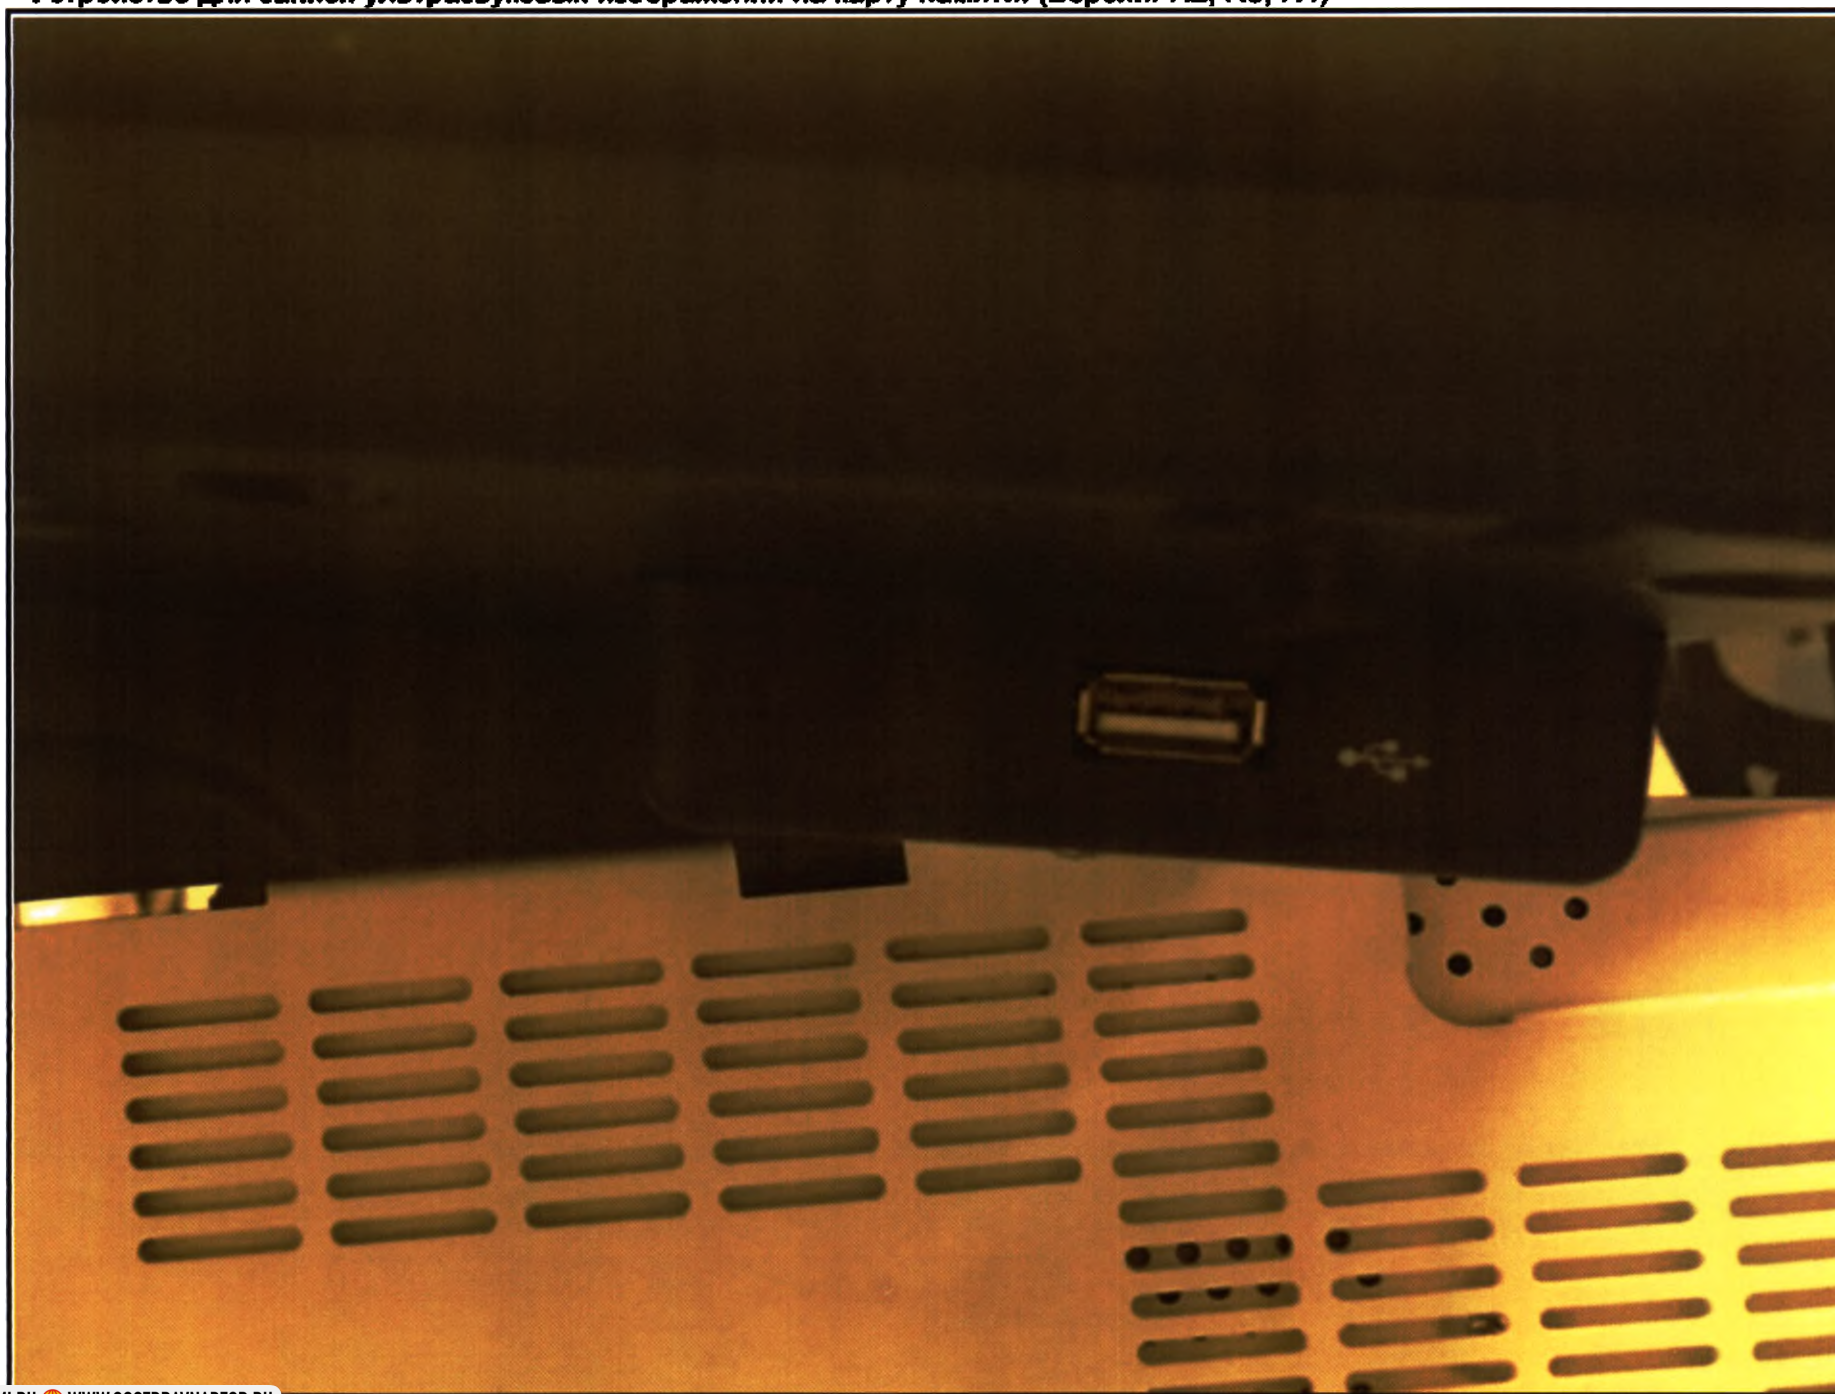

Устройство для записи ультразвуковых изображений на карту памяти. (Версии: R2, R3, R4)

TCP/IP	Device	Service	Dataflow	Button	Remove
Destination Device MyComputer ▼					
Select Service Type to Add ▼			Add		
Service					
Copy to Dataflow			Remove		
HD Export					
Local Archive - Int HD					
USB Drive F					
USB Drive H					
USB Quick Save					
Properties					
Destination USB Key ▼					
			USB Key		
			NetworkStorage		
Properties					
Name USB Quick Save					

Устройство для записи ультразвуковых изображений на CD и DVD диски. (Версии: R2, R3, R4)



Устройство для записи ультразвуковых изображений на внешний жесткий диск . (Версии: R2, R3, R4)



Система, обеспечивающая возможность беспроводной передачи данных. (Версии: R2, R3, R4)




Система, обеспечивающая возможность беспроводной передачи данных. (Версии: R2, R3, R4)




Устройство видеозаписывающее. (Версии: R2, R3, R4)




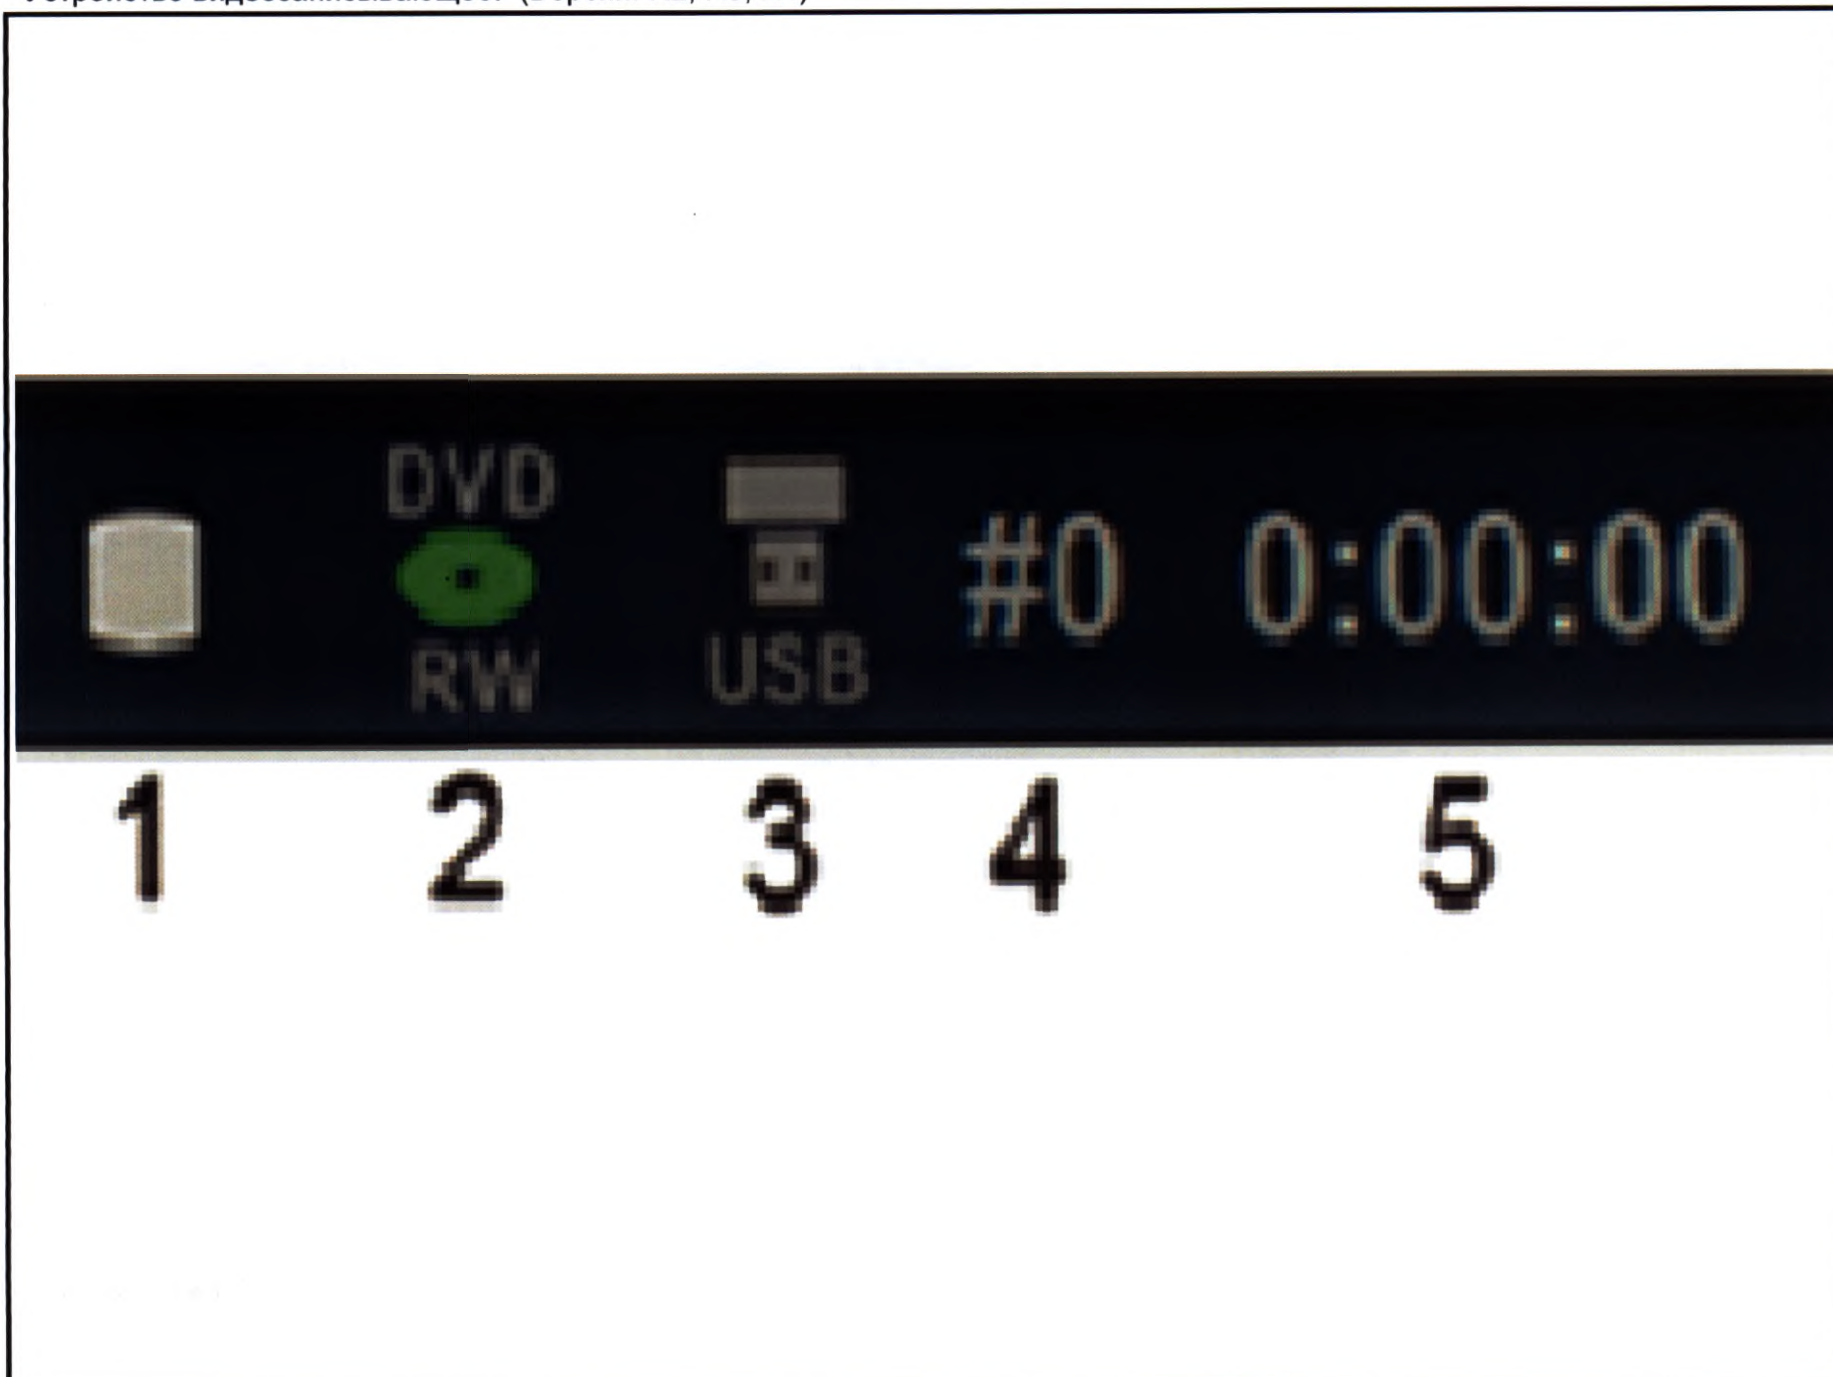


Устройство видеозаписывающее. (Версии: R2, R3, R4)

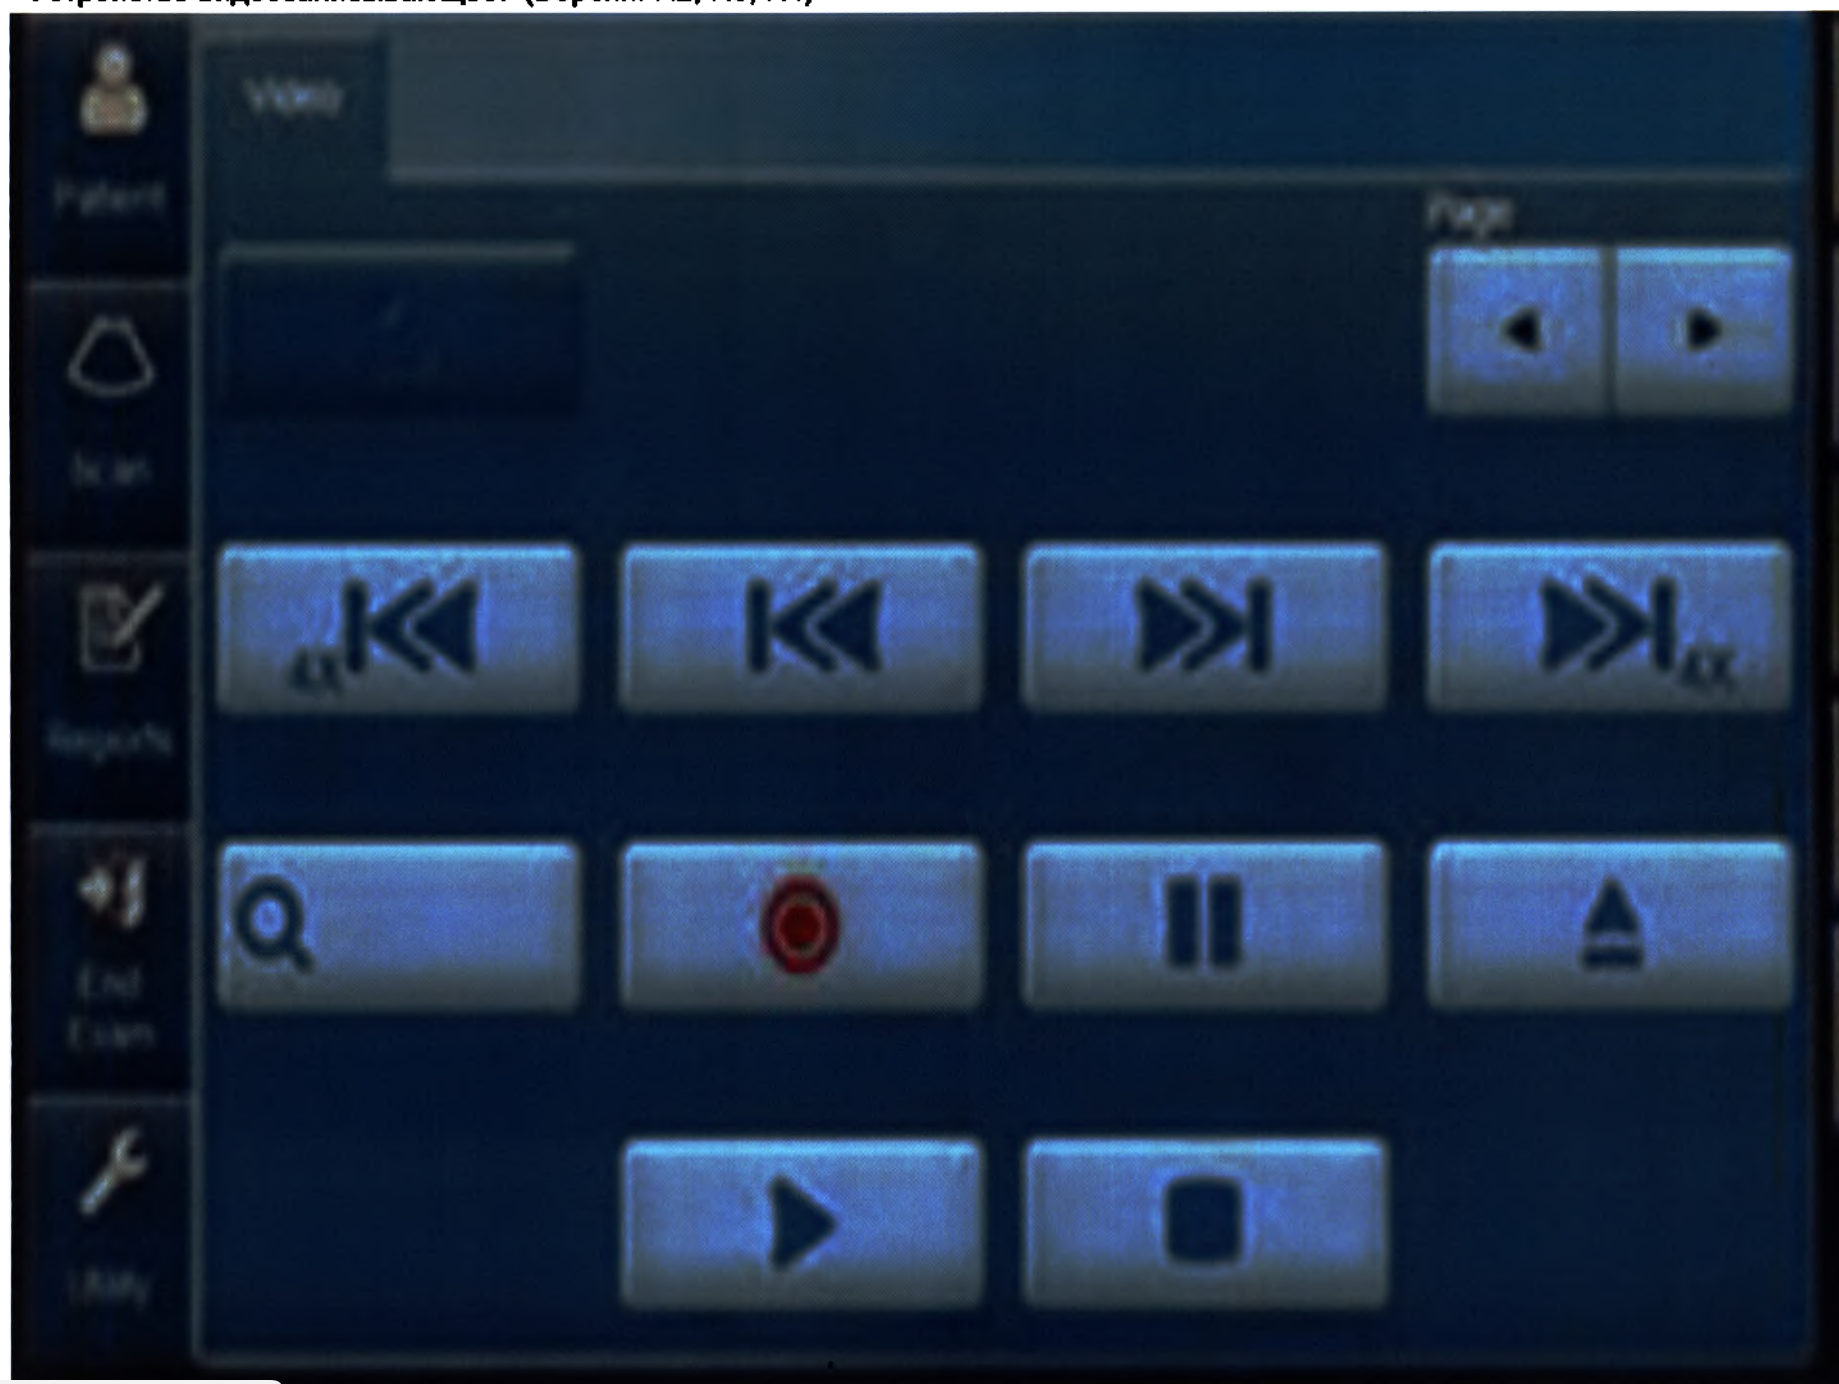

Устройство видеозаписывающее. (Версии: R2, R3, R4)

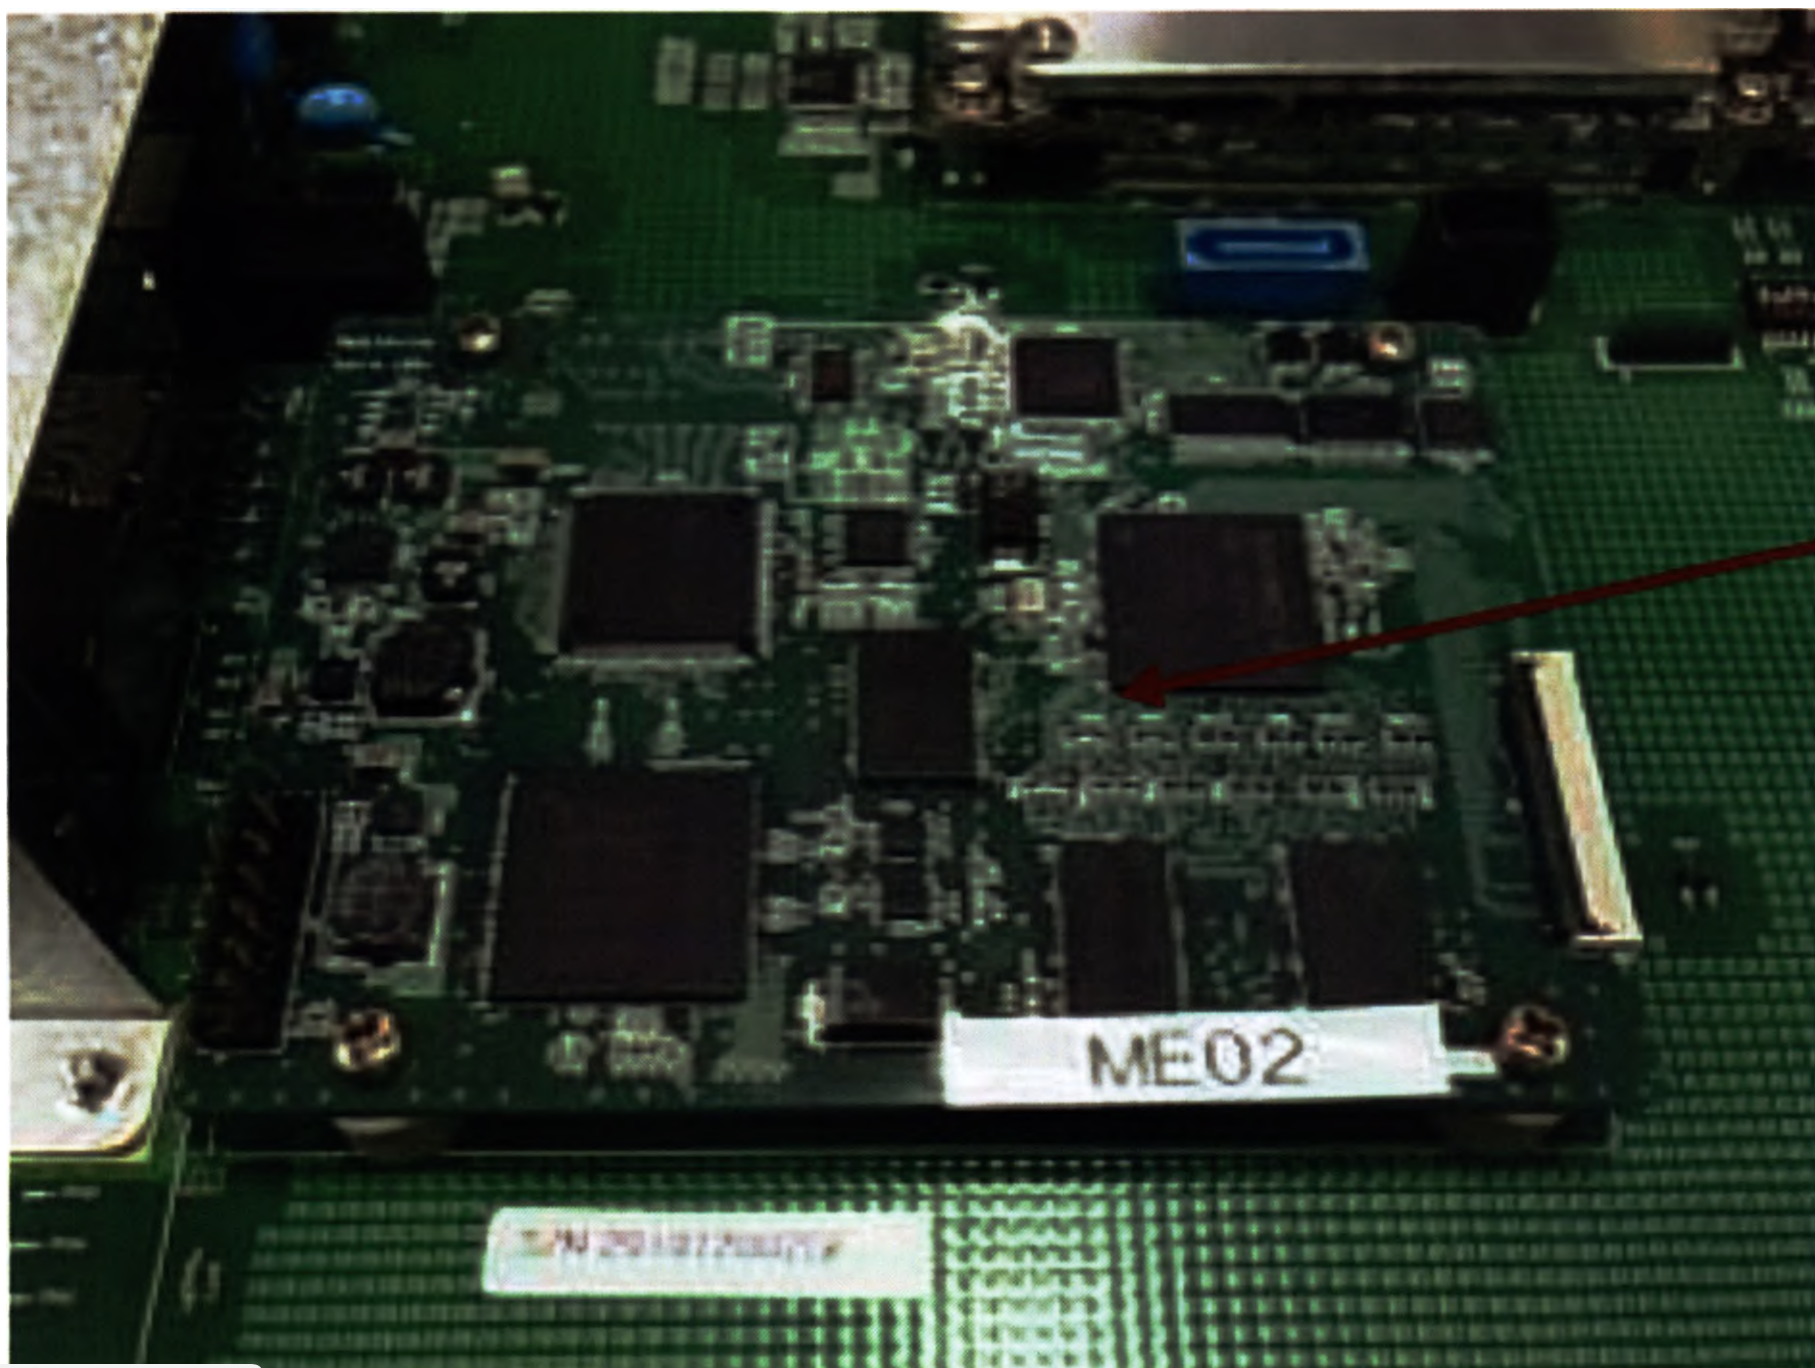

Кабели для подключений устройства видеозаписывающего. (Версии: R2, R3, R4)

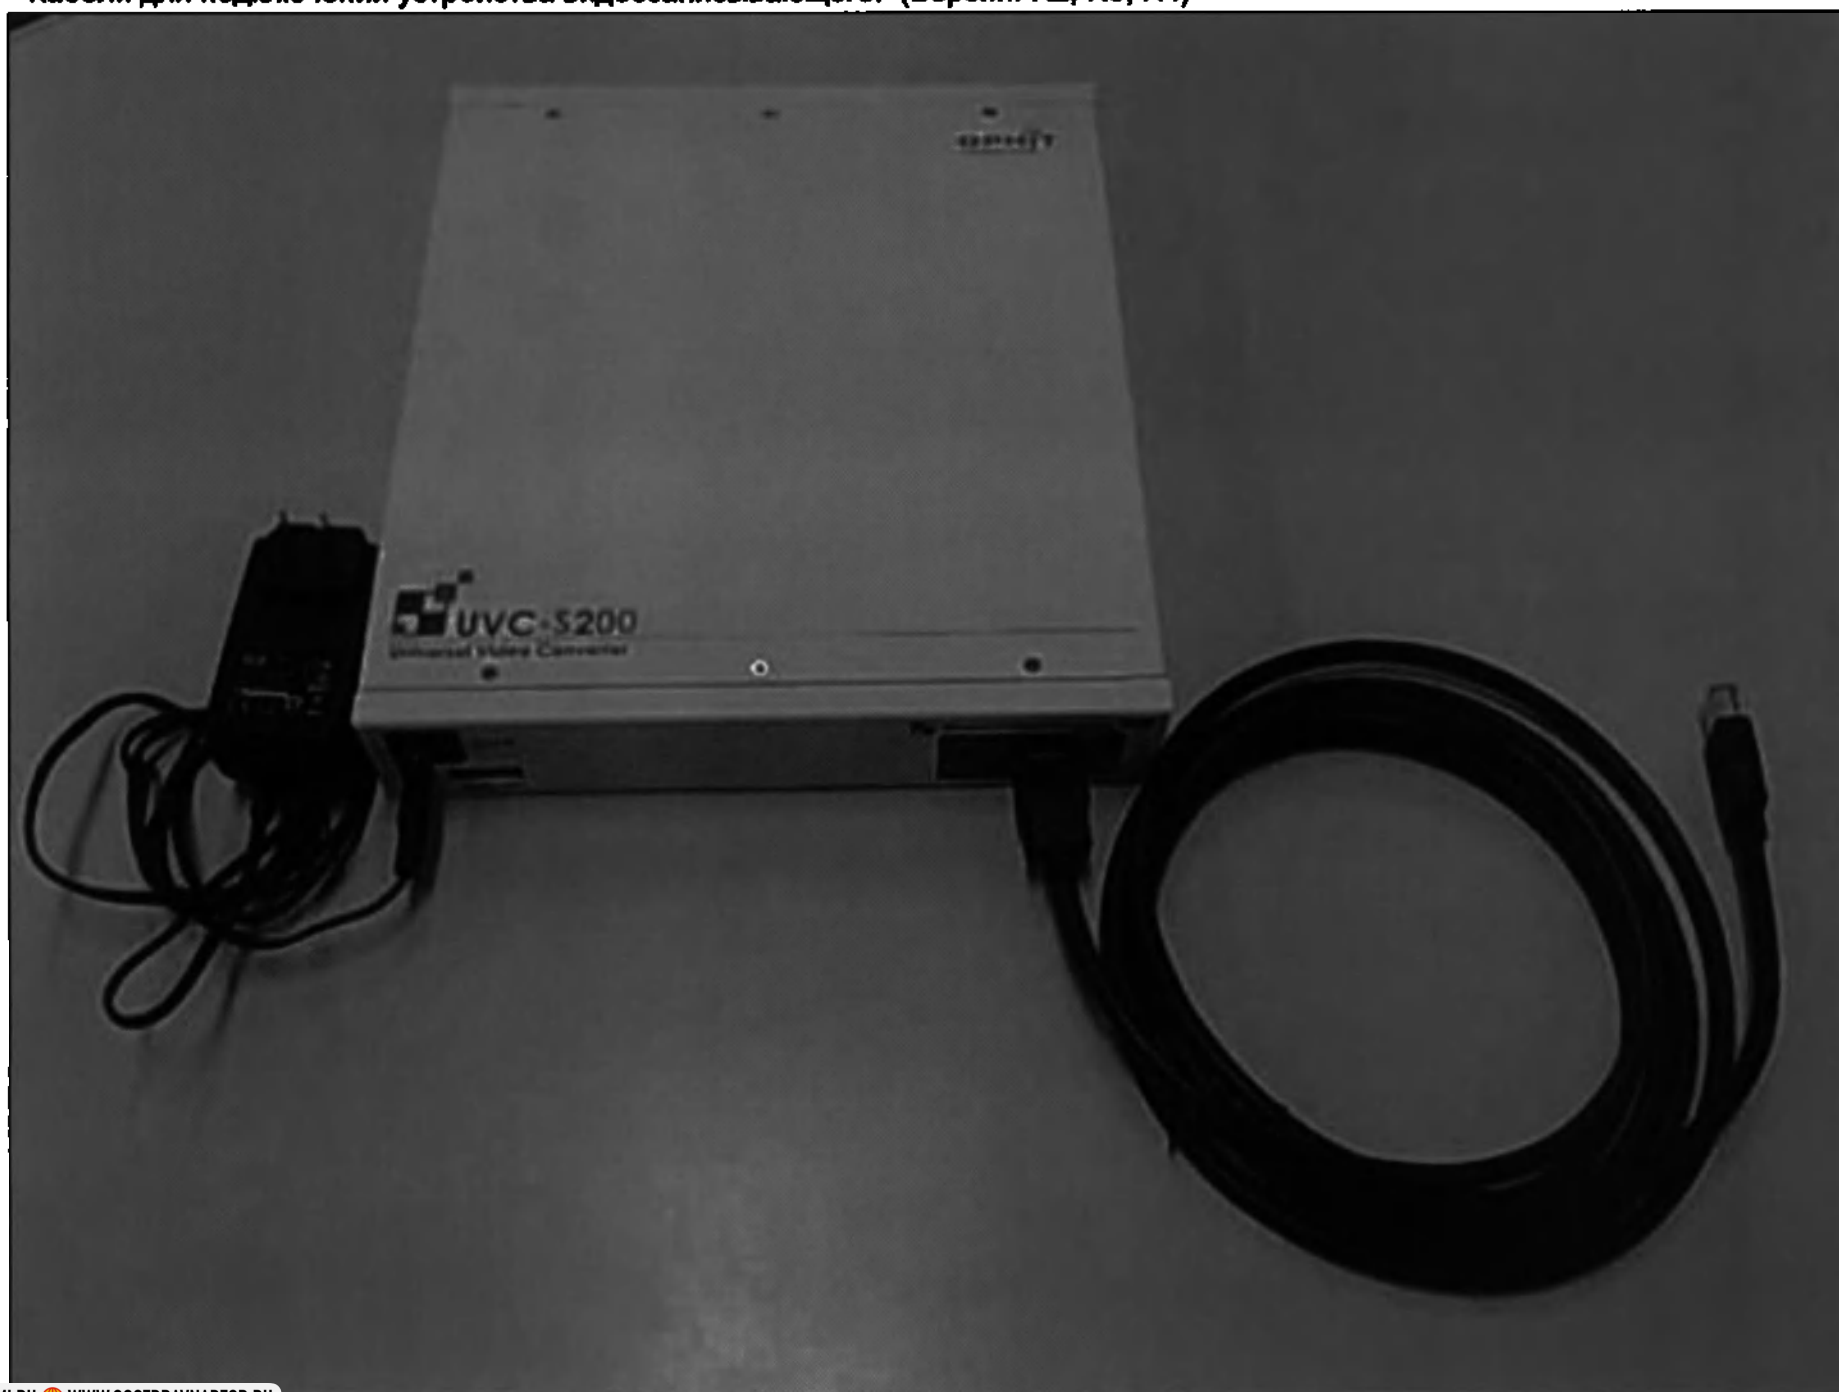

Крепление для устройства видеозаписывающего. (Версии: R2, R3, R4)



Крепление для устройства видеозаписывающего. (Версии: R2, R3, R4)



Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения. (Версии: R2, R3, R4)




Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения. (Версии: R2, R3, R4)



Термобумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (не более 100 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Термобумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (не более 100 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

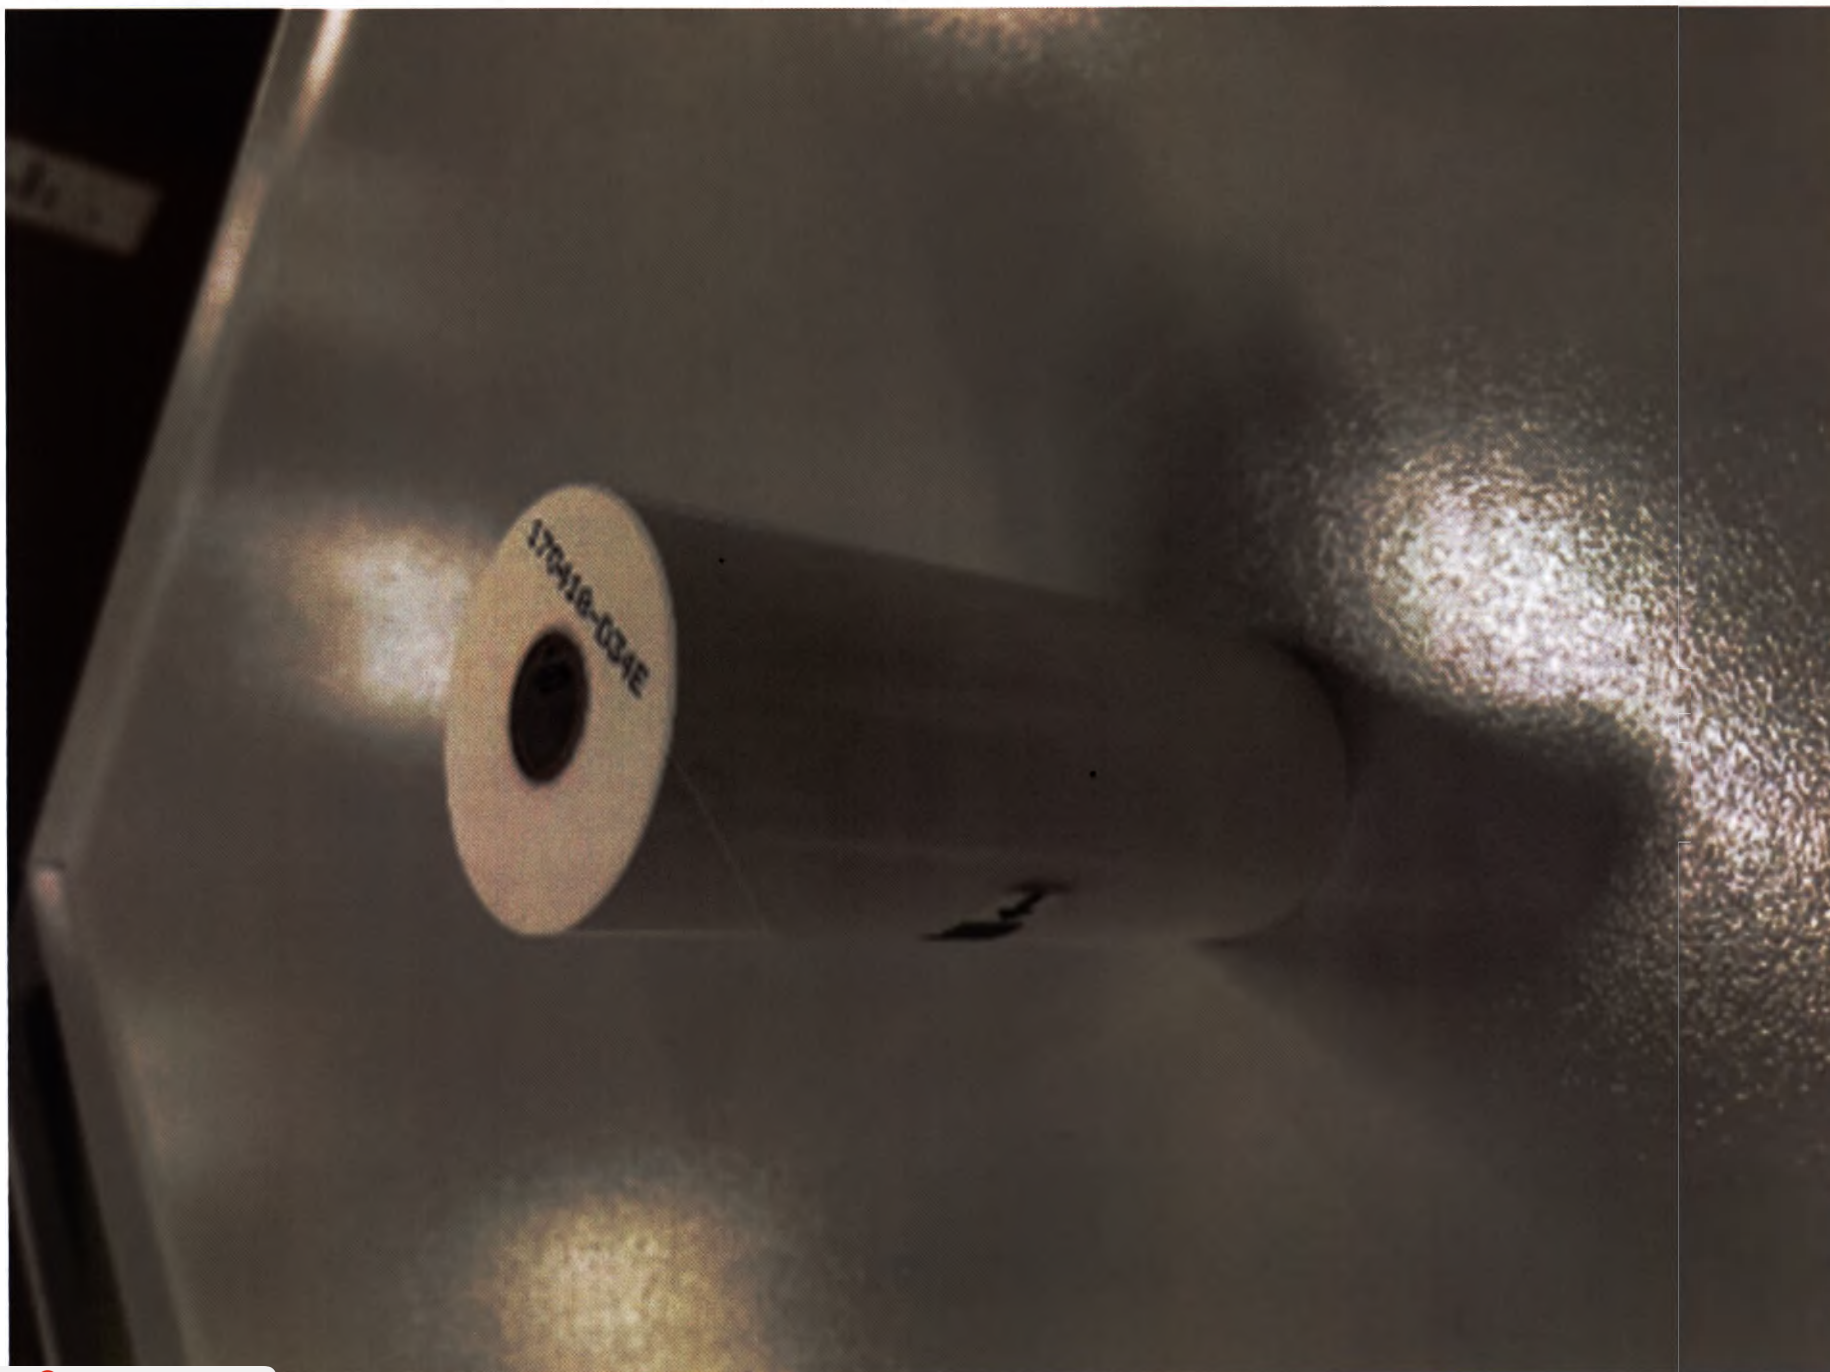

Кабели для подключения устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Крепление для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения. (Версии: R2, R3, R4)

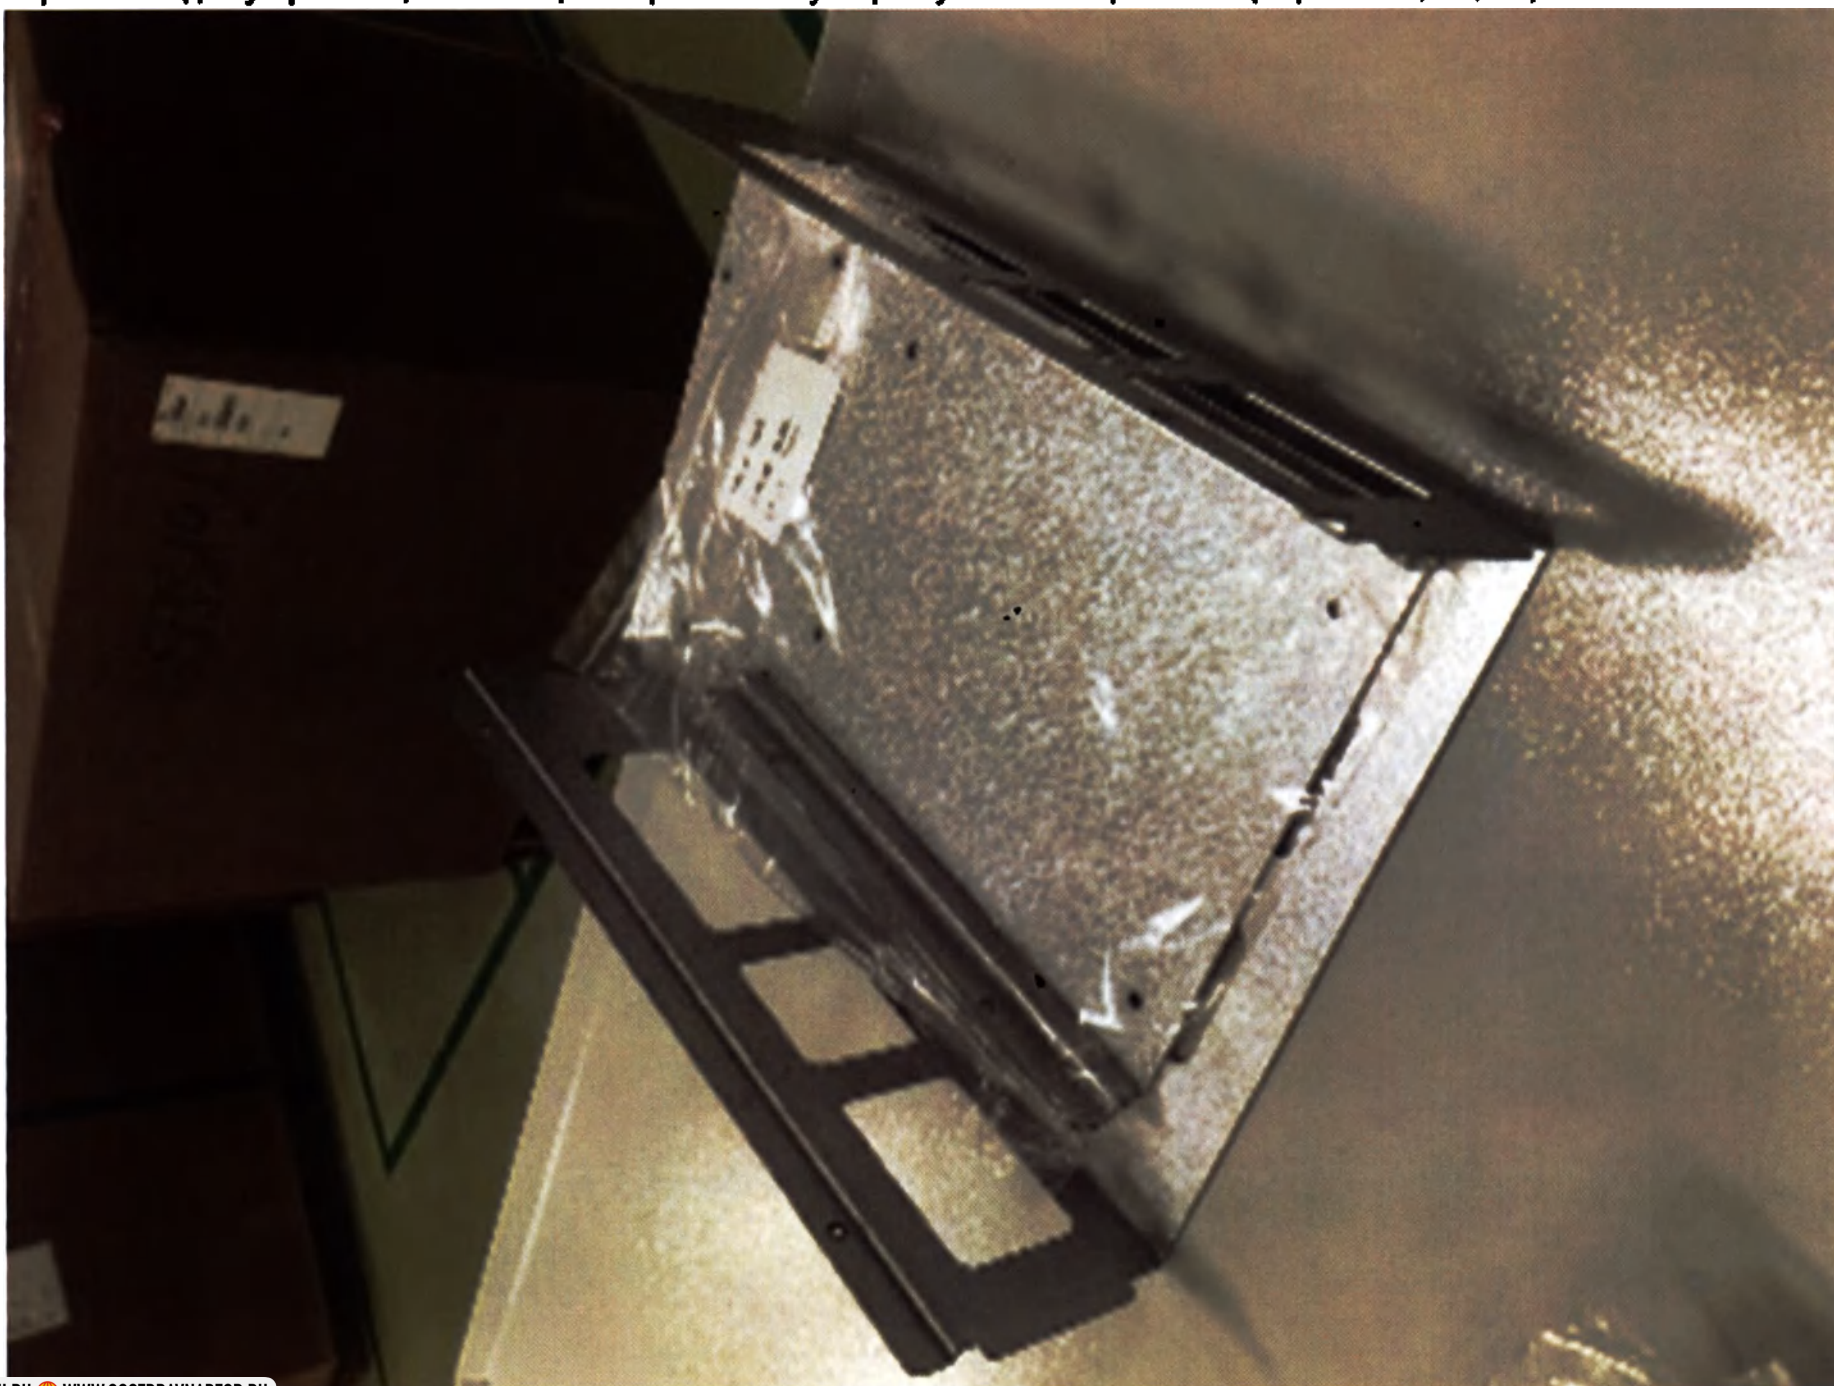


Устройство, печатающее цветные ультразвуковые изображения. (Версии: R2, R3, R4)



Термобумага для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения (не более 100 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Кабели для подключения устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

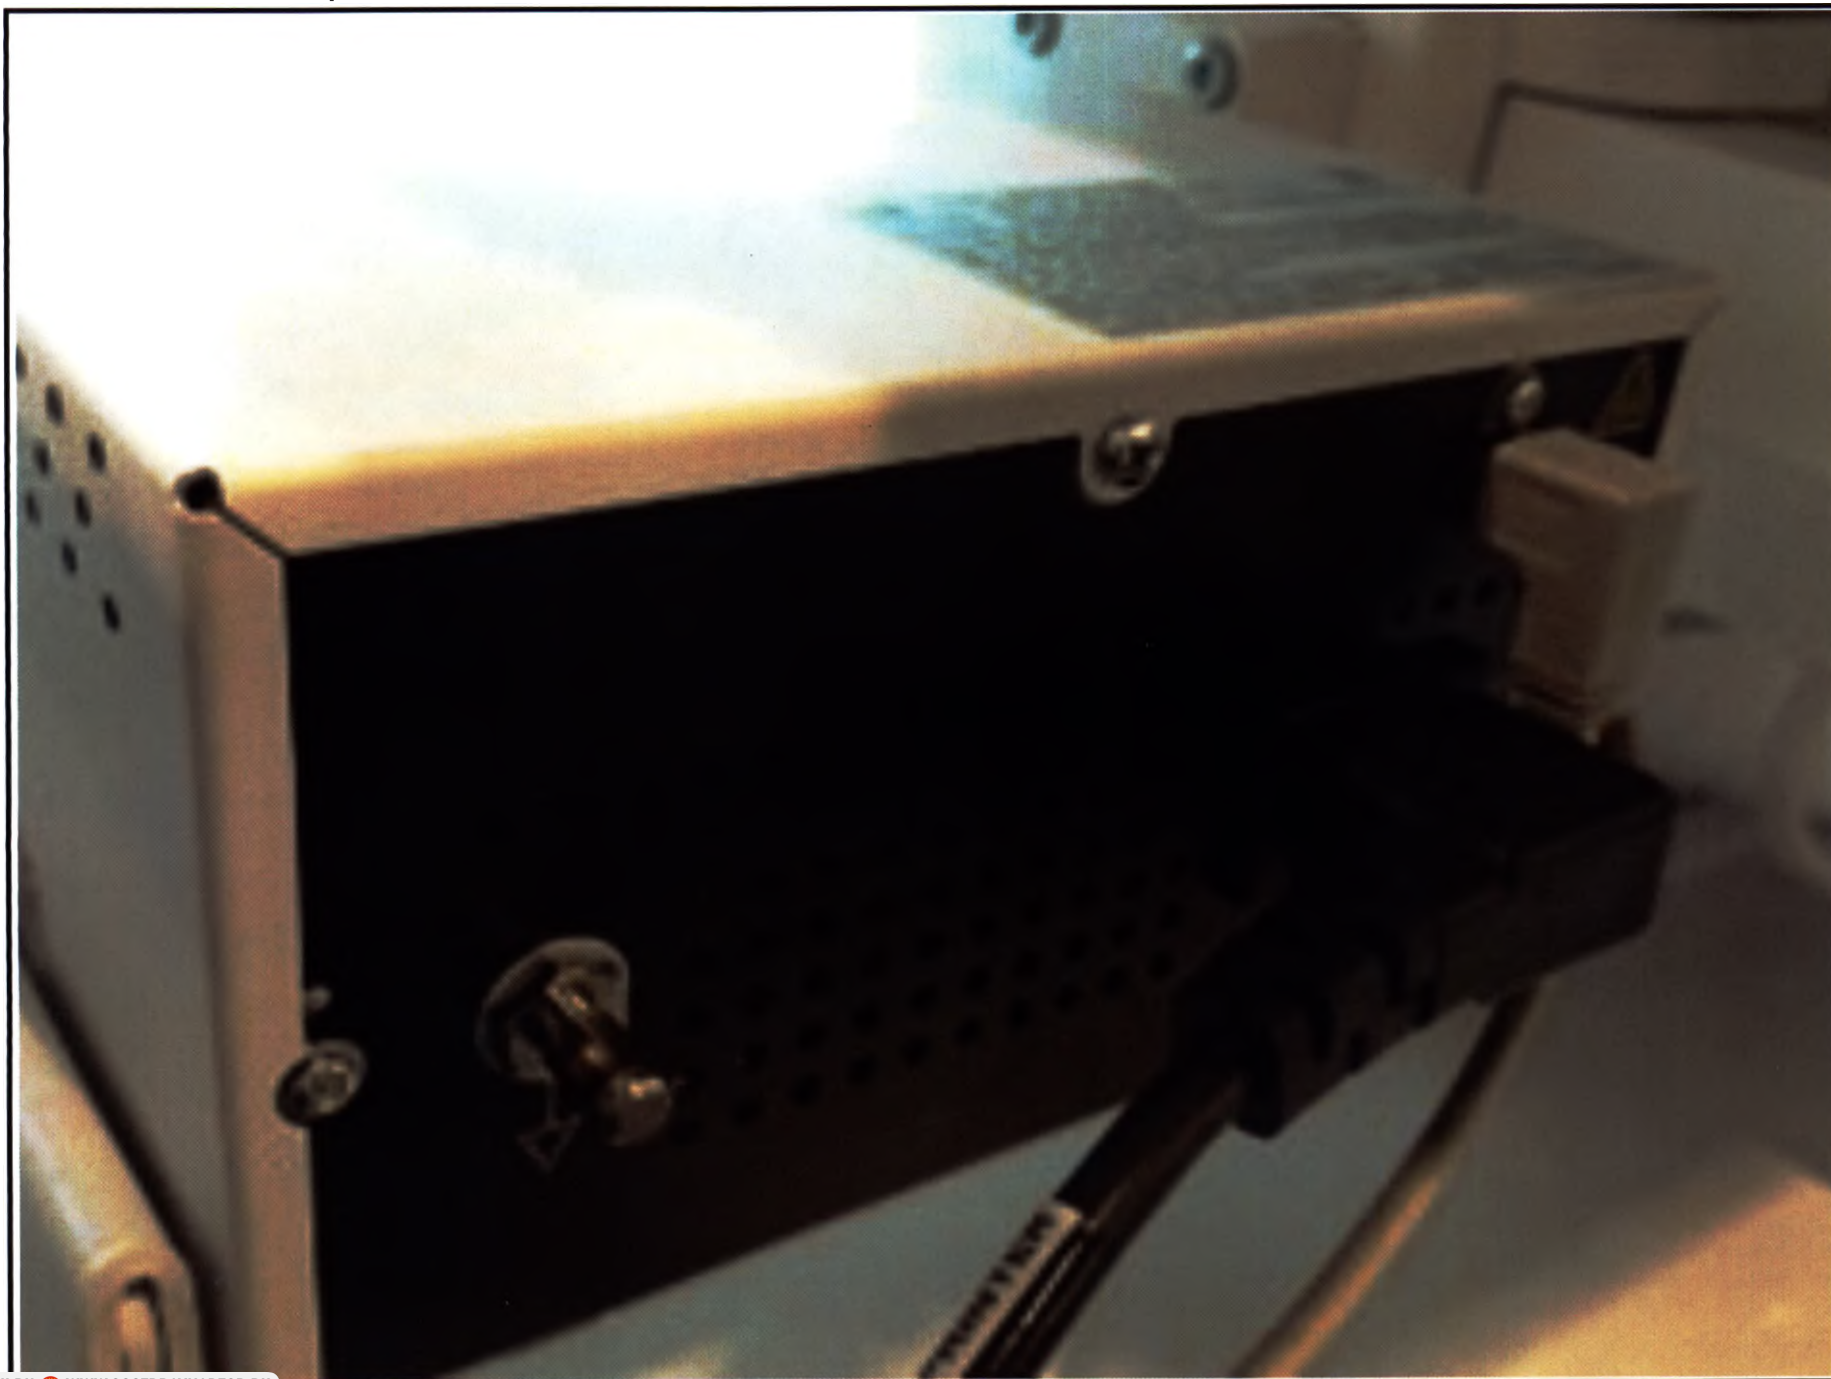

Крепление для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения. (Версии: R2, R3, R4)




Крепление для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения. (Версии: R2, R3, R4)





Станция рабочая для хранения и обработки ультразвуковых изображений (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

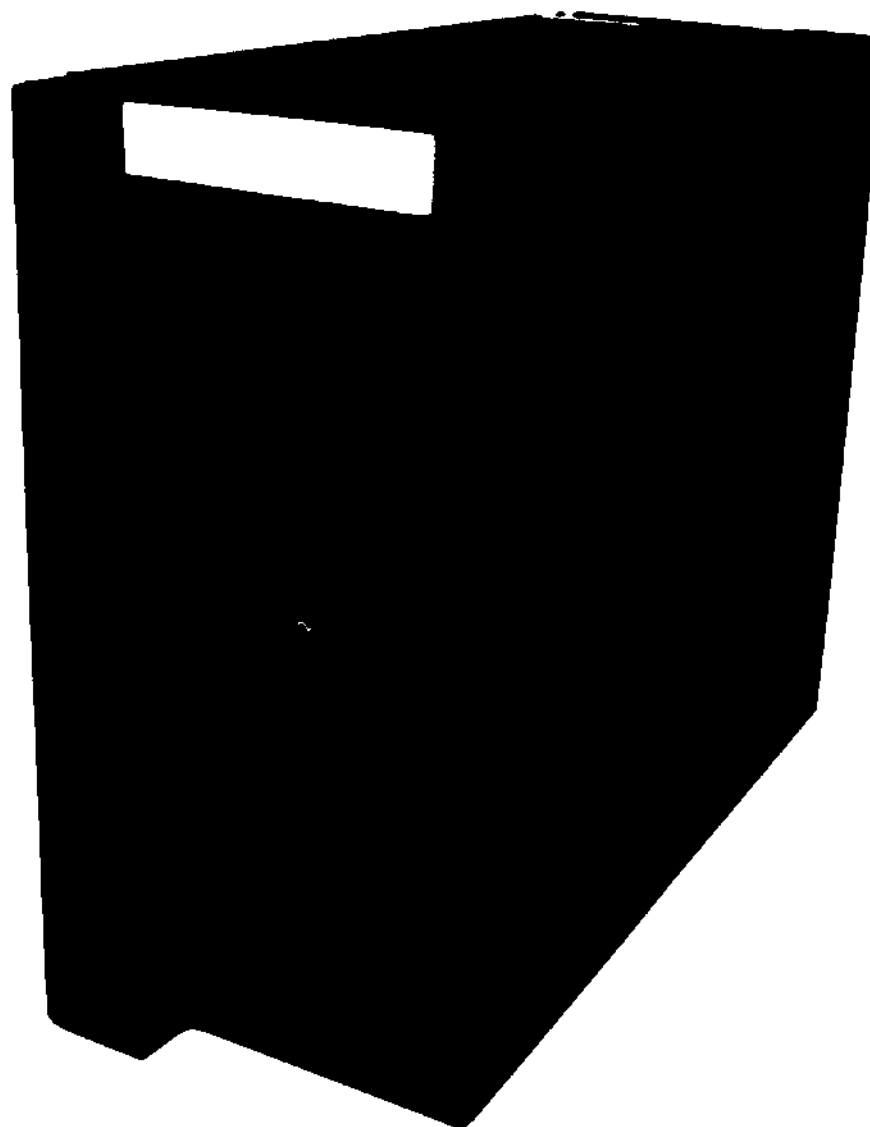


Источник бесперебойного питания (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Источник бесперебойного питания (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Монитор для рабочей станции (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Держатели для датчиков (не более 10 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Дополнительная рукоятка для транспортировки. (Версии: R2, R3, R4)



Держатели кабелей датчиков (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

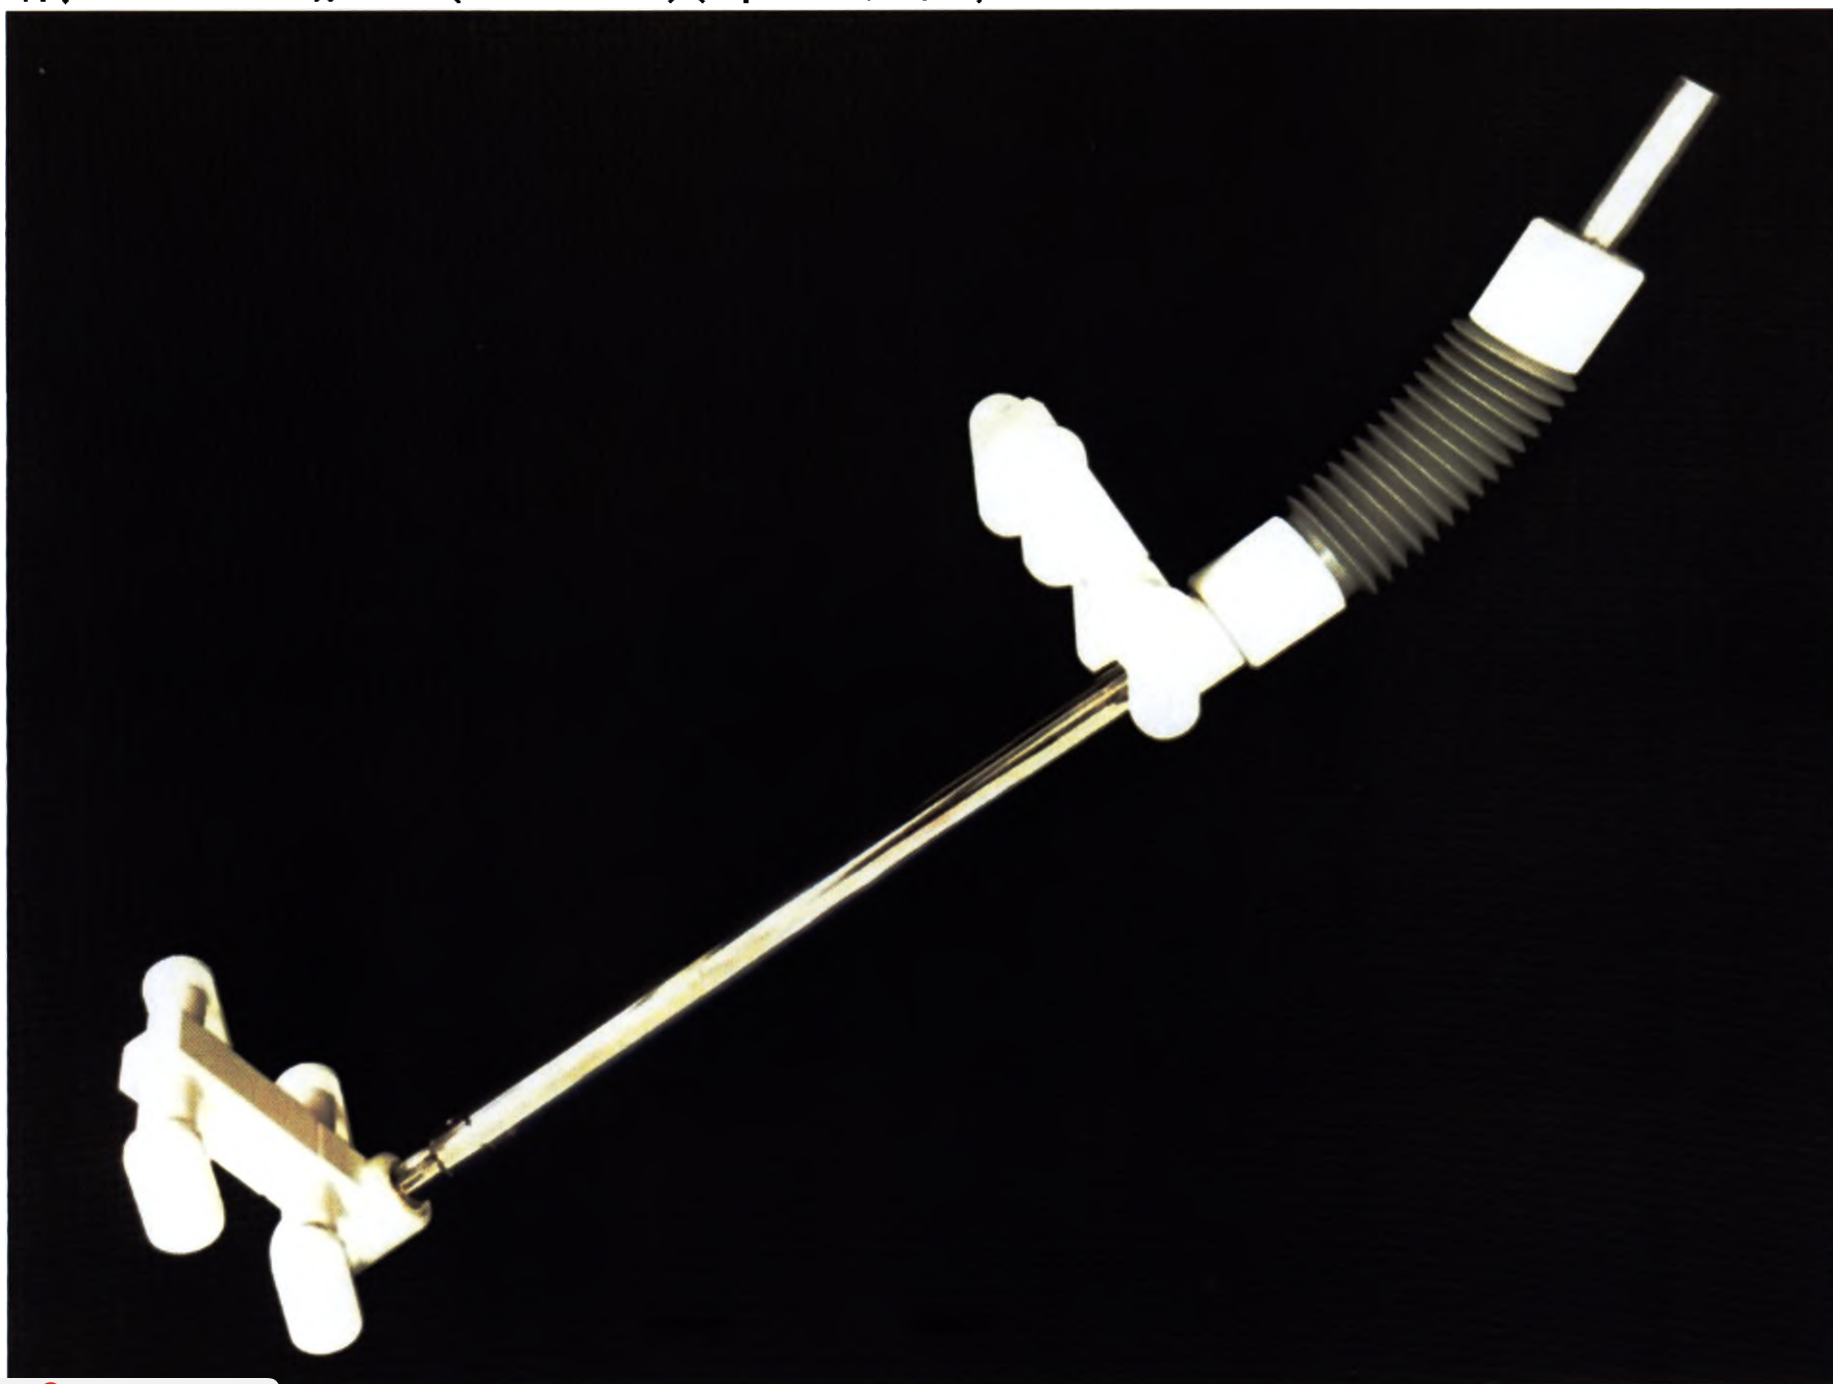

Держатели кабелей датчиков (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)



Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

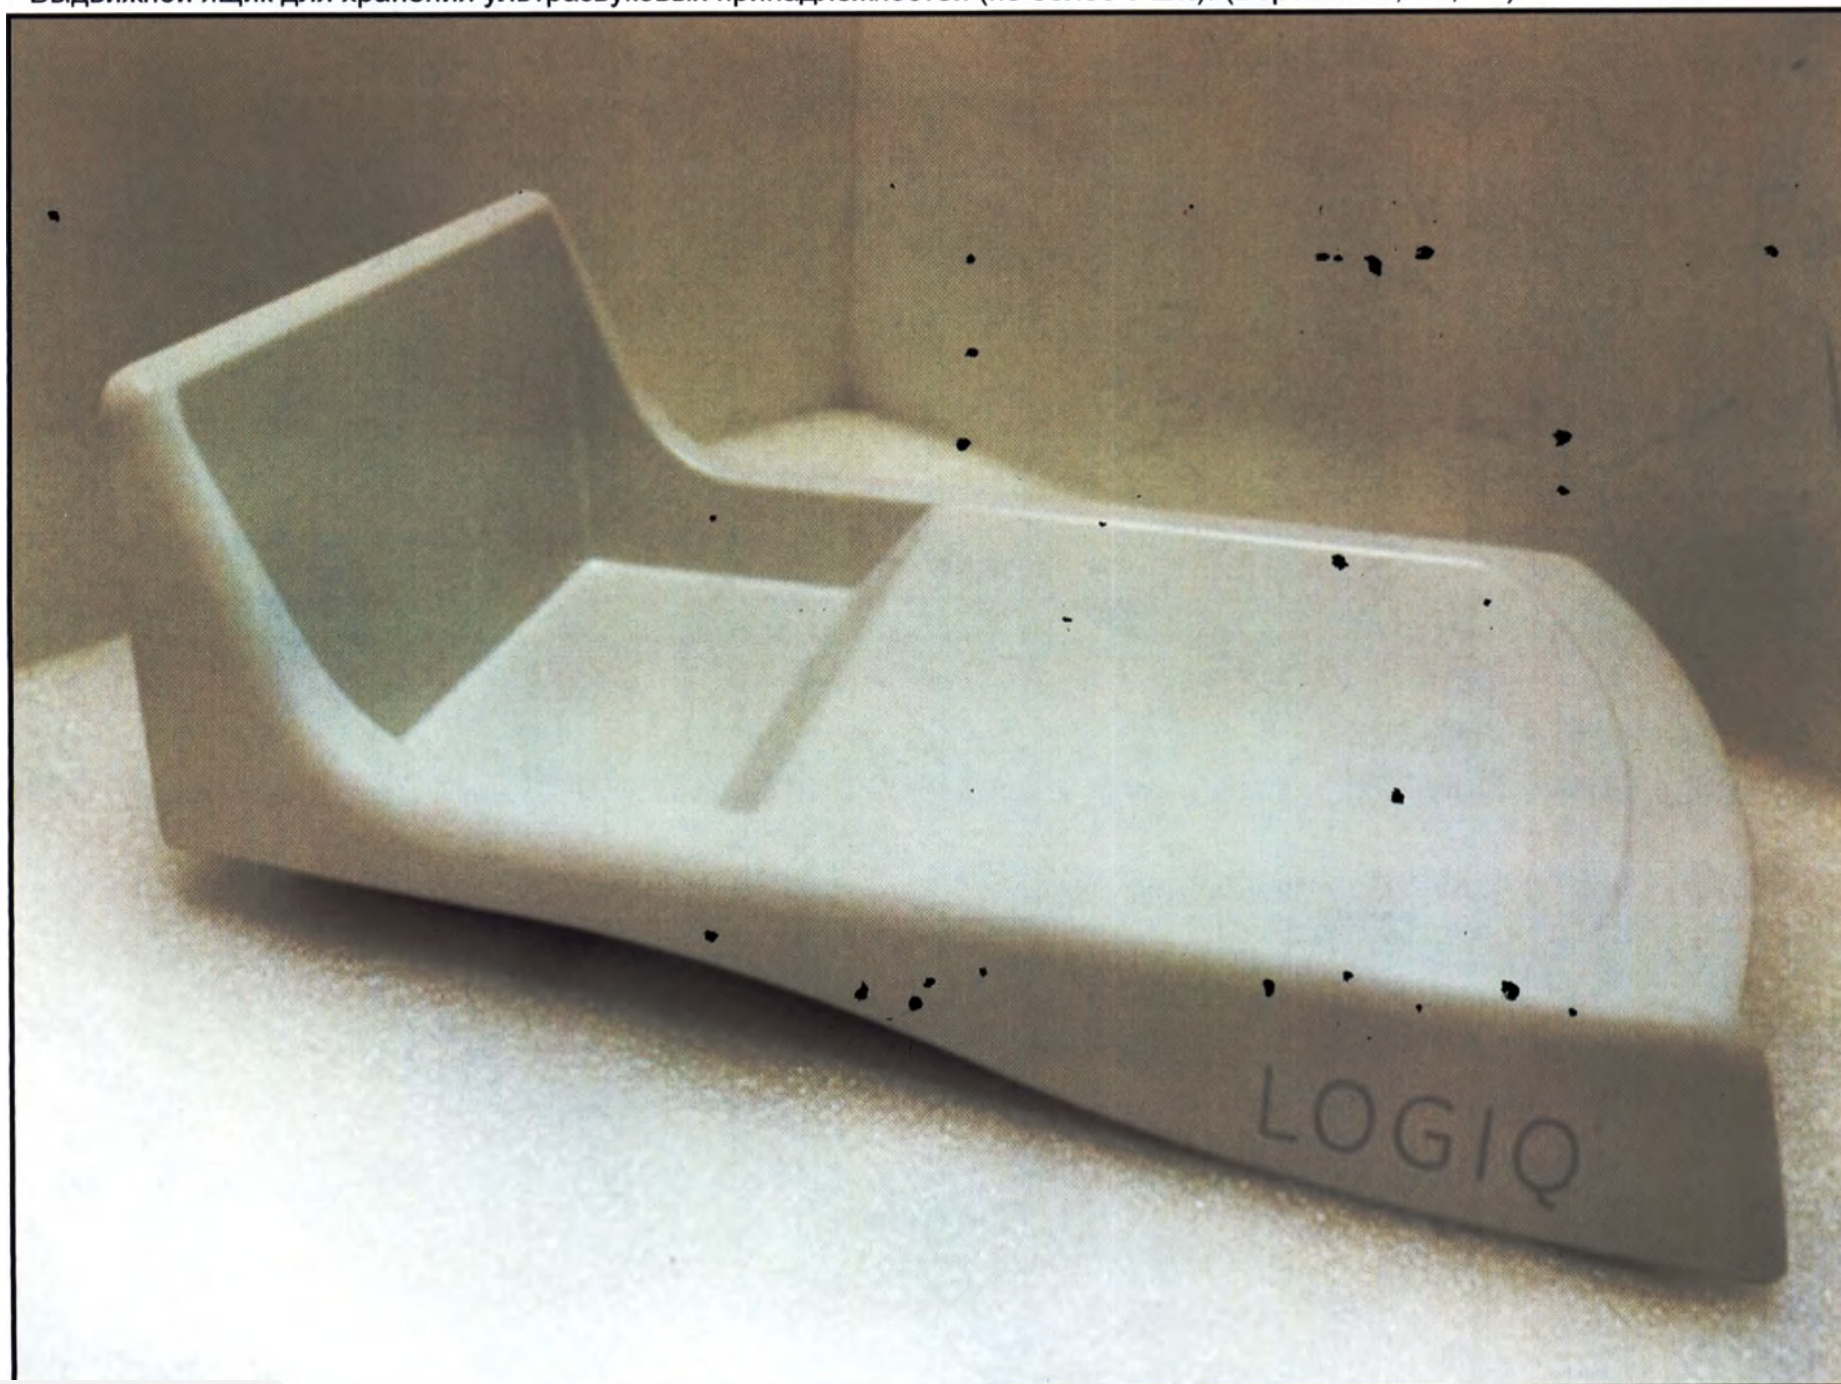

Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

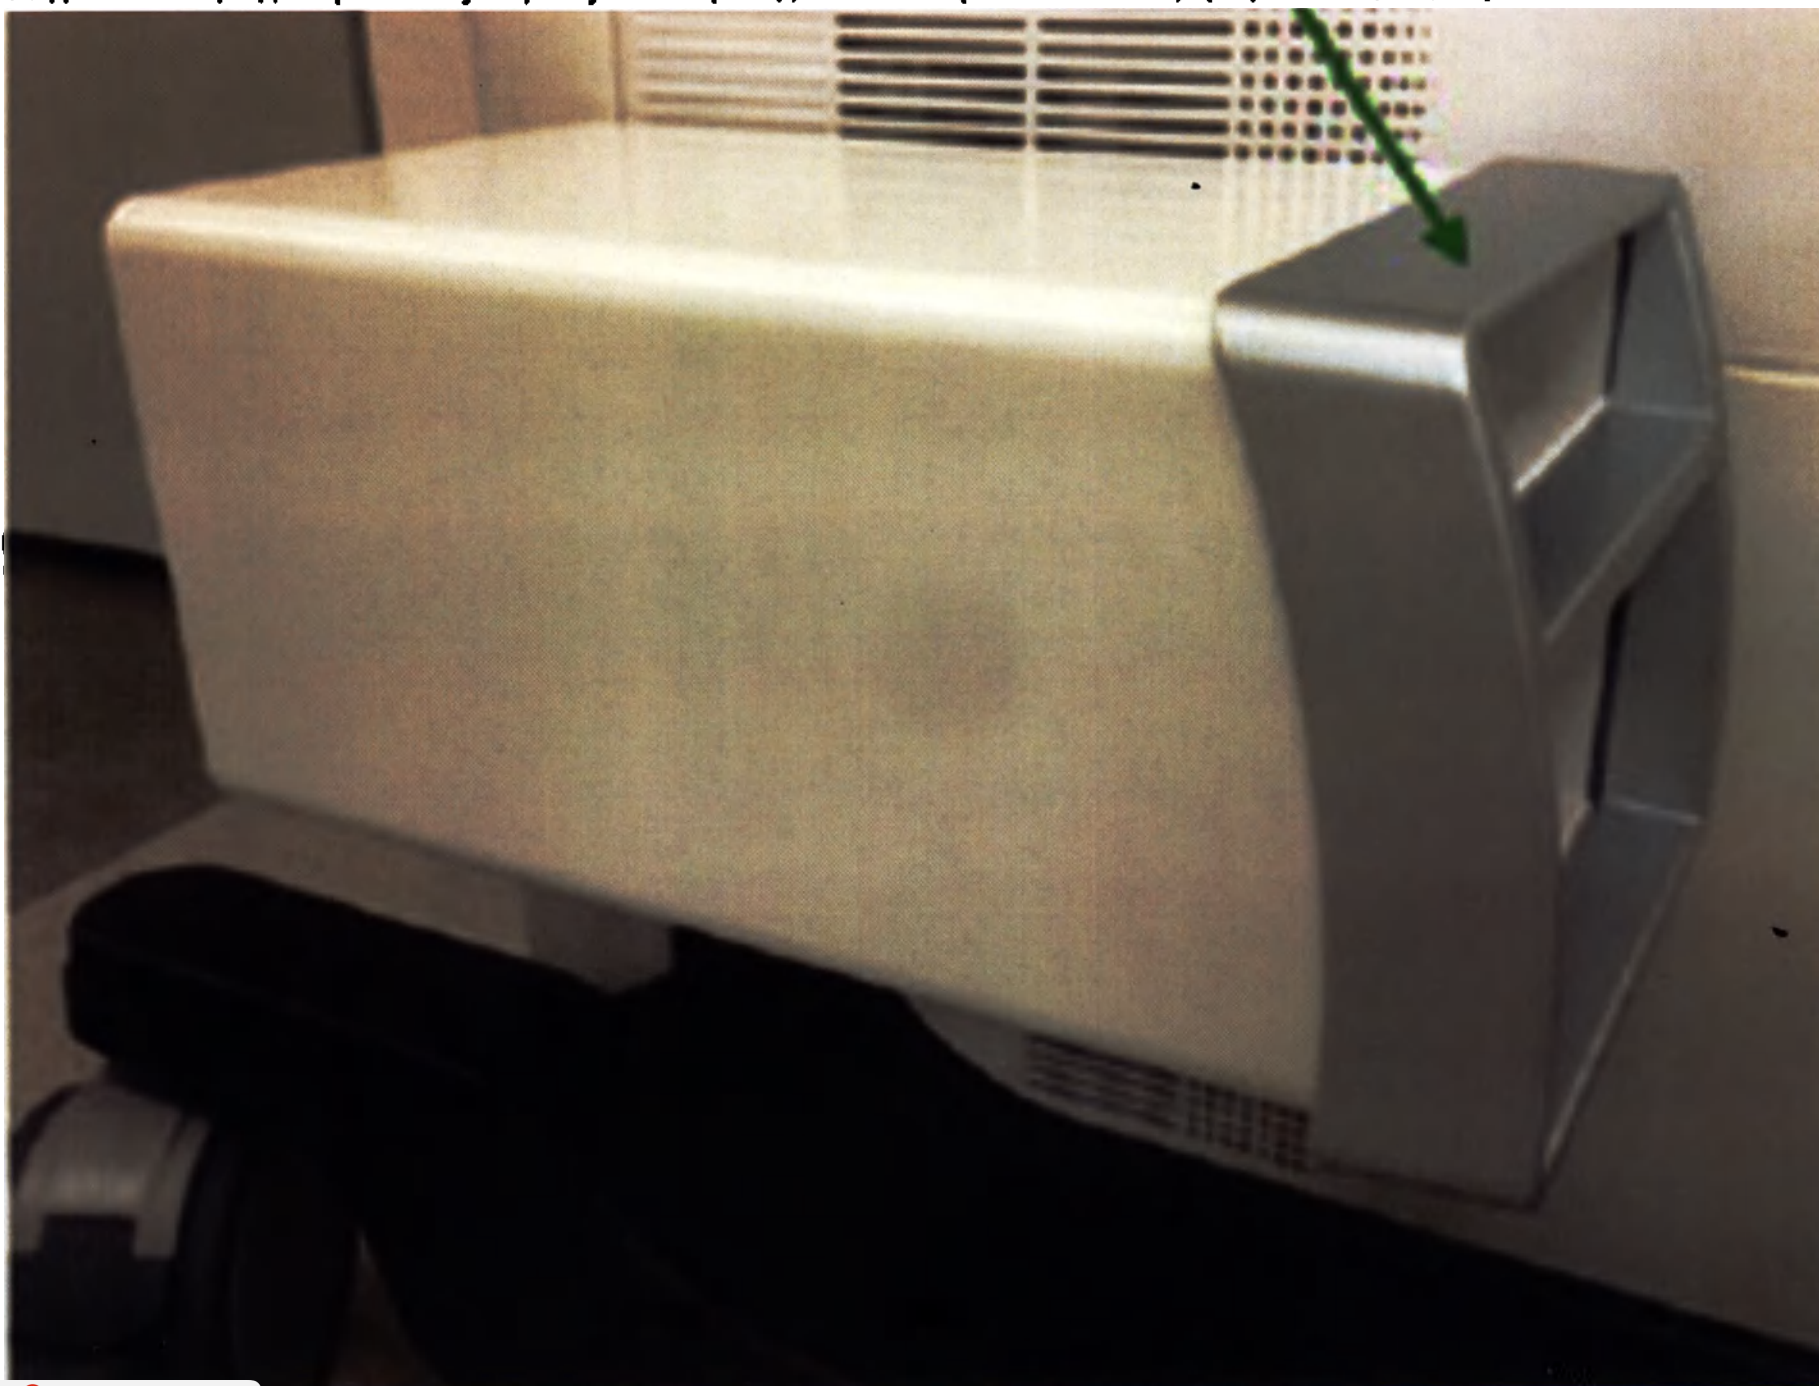


Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

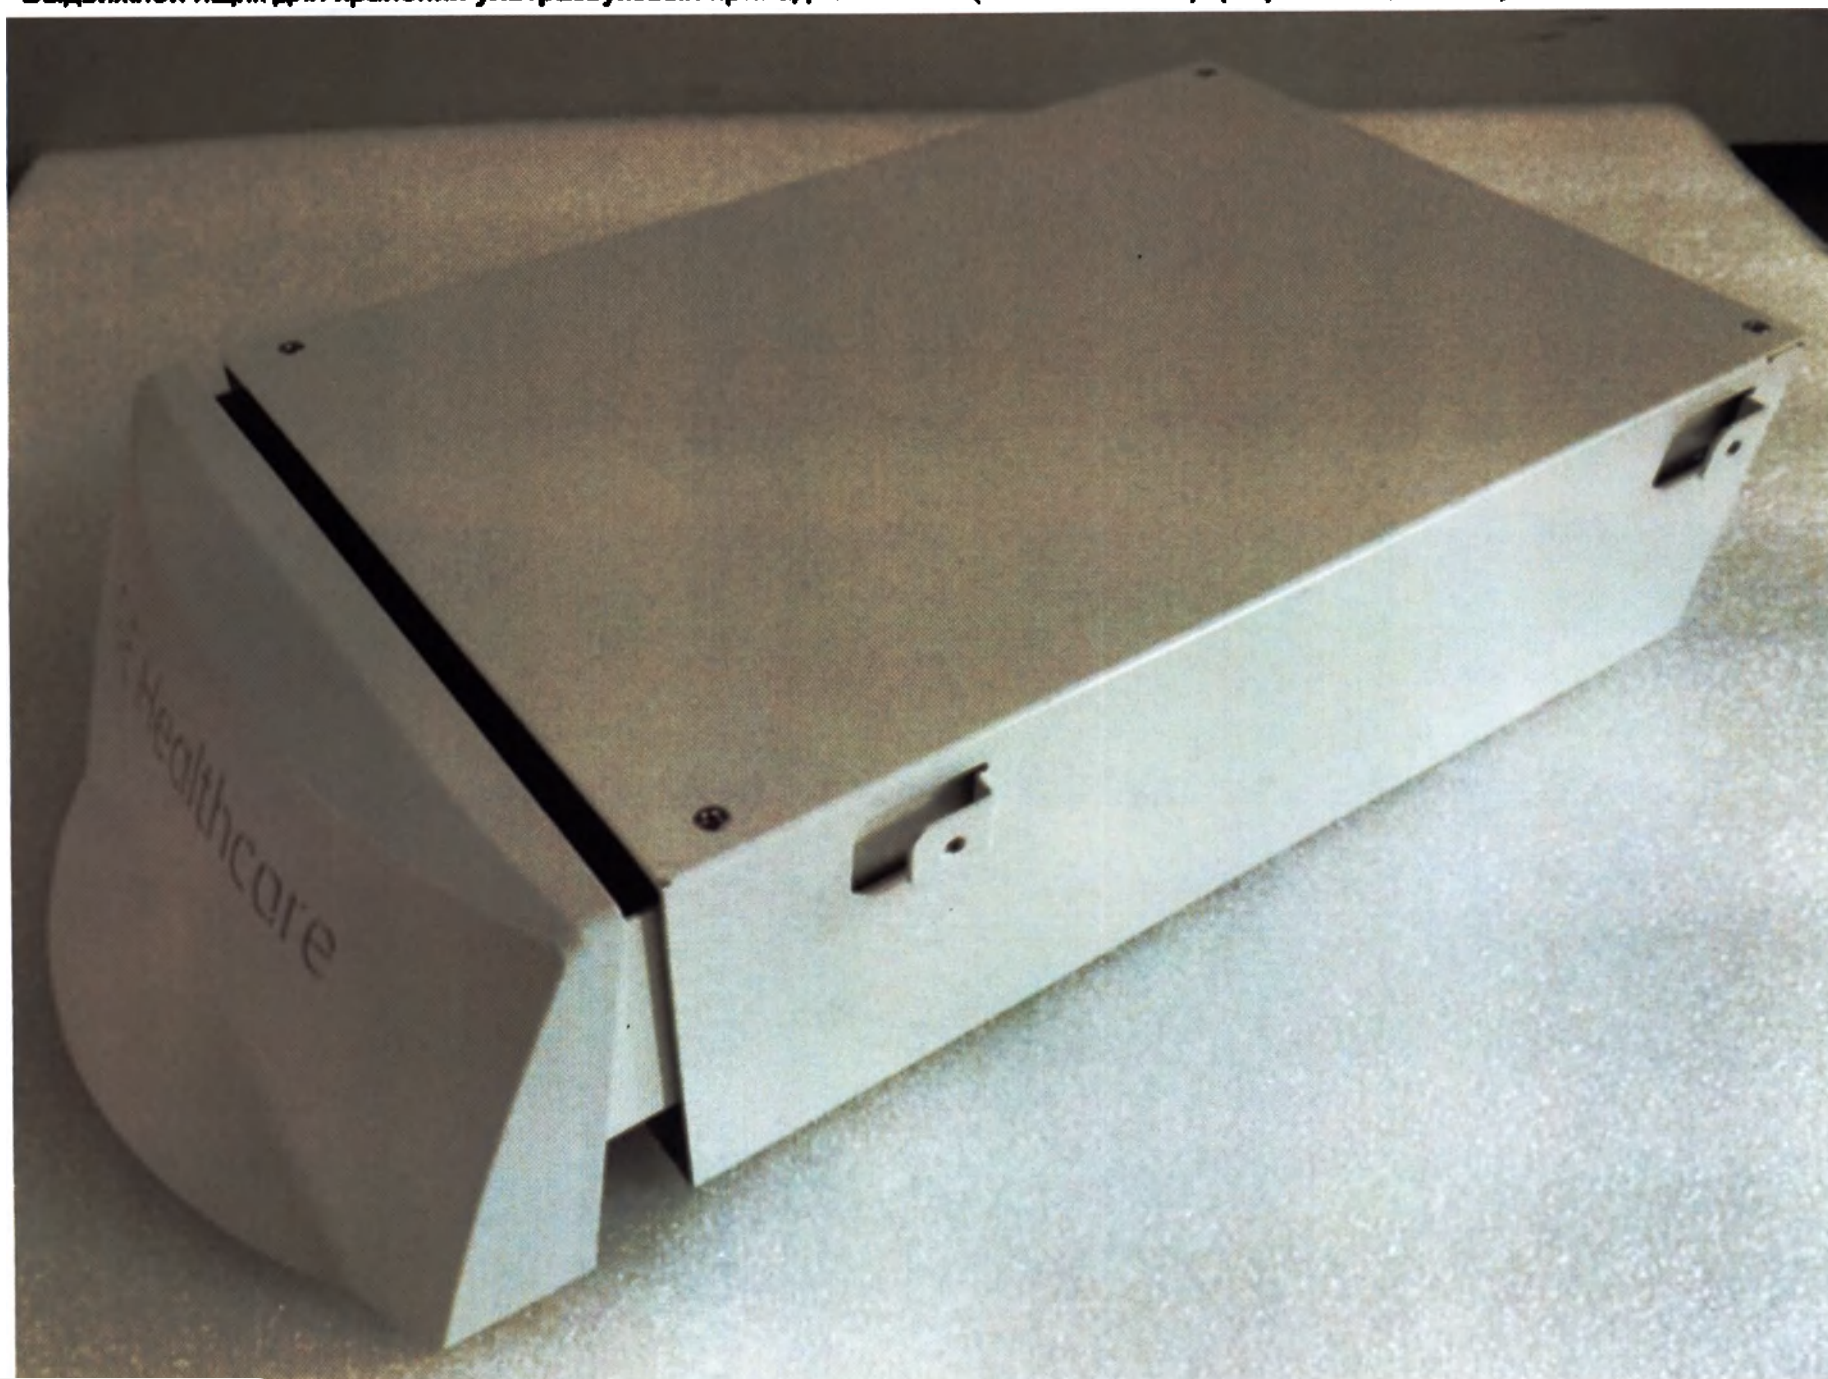

Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Выдвижной ящик для хранения ультразвуковых принадлежностей (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

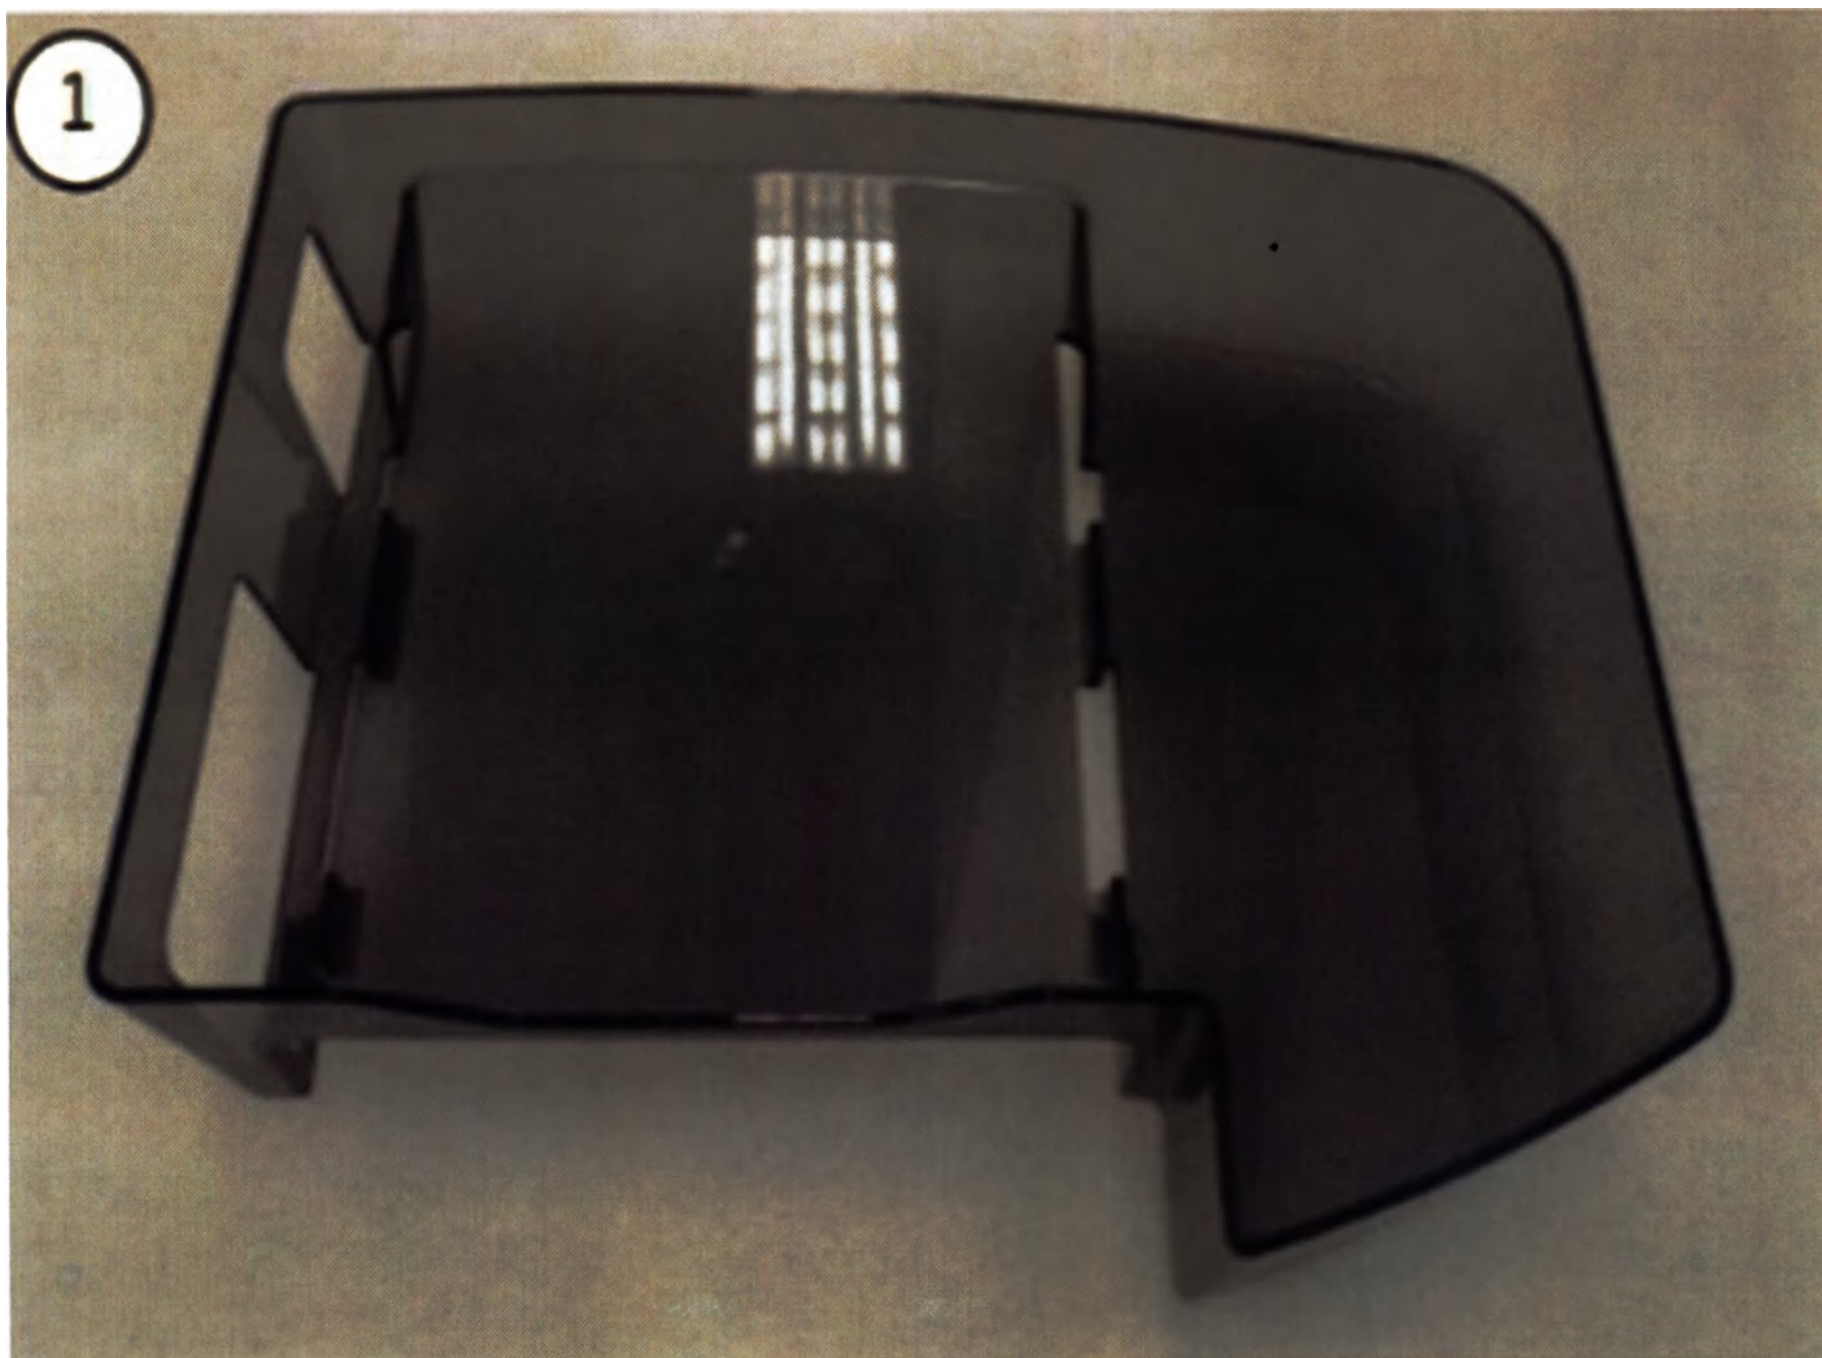

Дополнительная лампа освещения панели управления. (Версии: R2, R3, R4)



Защитные чехлы для системы ультразвуковой диагностической (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

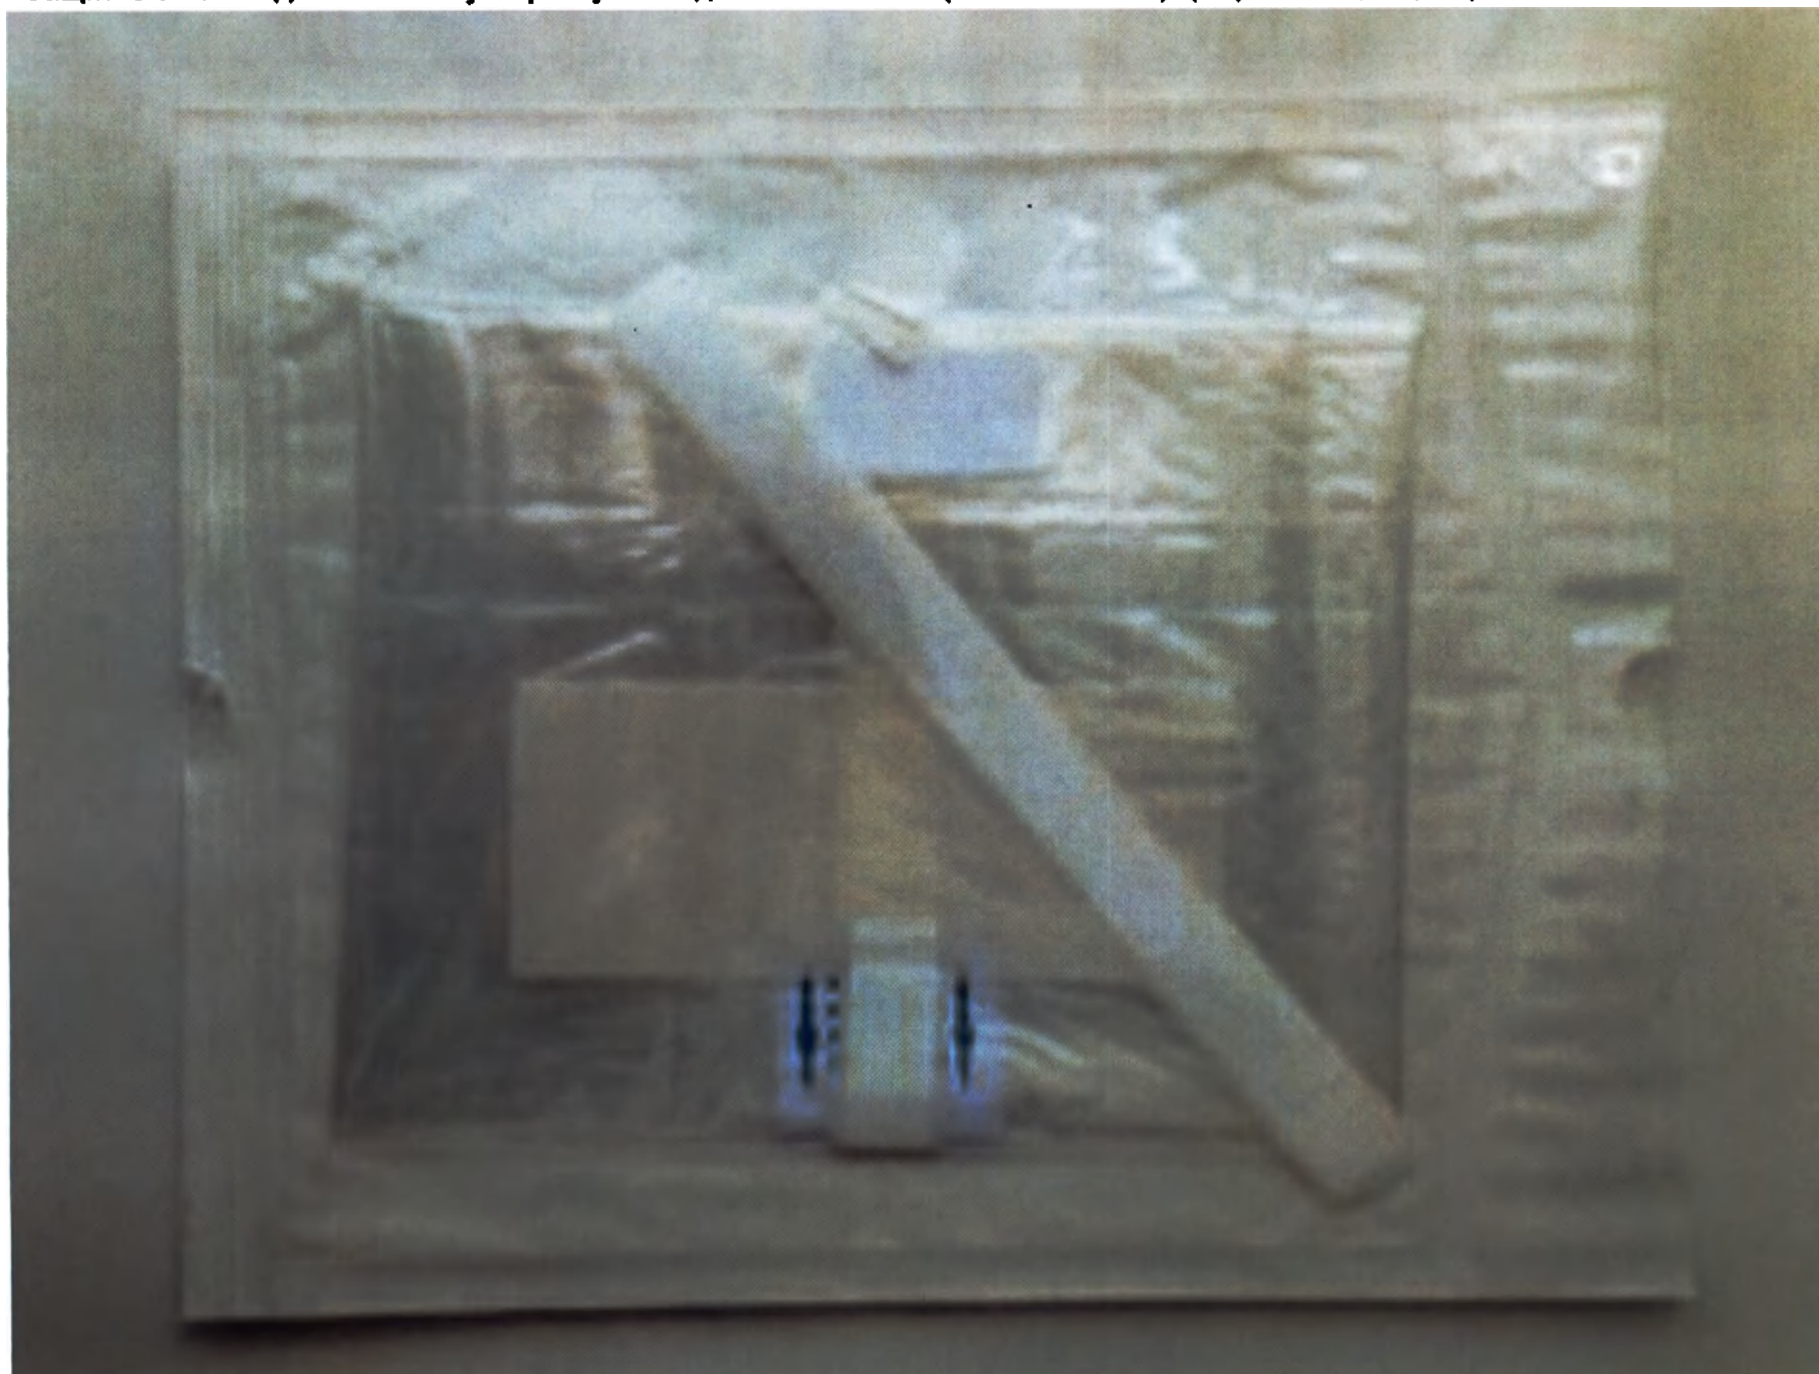


Дополнительный специальный медицинский монитор для системы ультразвуковой диагностической. (Версии: R2, R3, R4)



Панель управления с кнопками. (Версии: R2, R3)



Панель управления с кнопками. (Версии: R4)

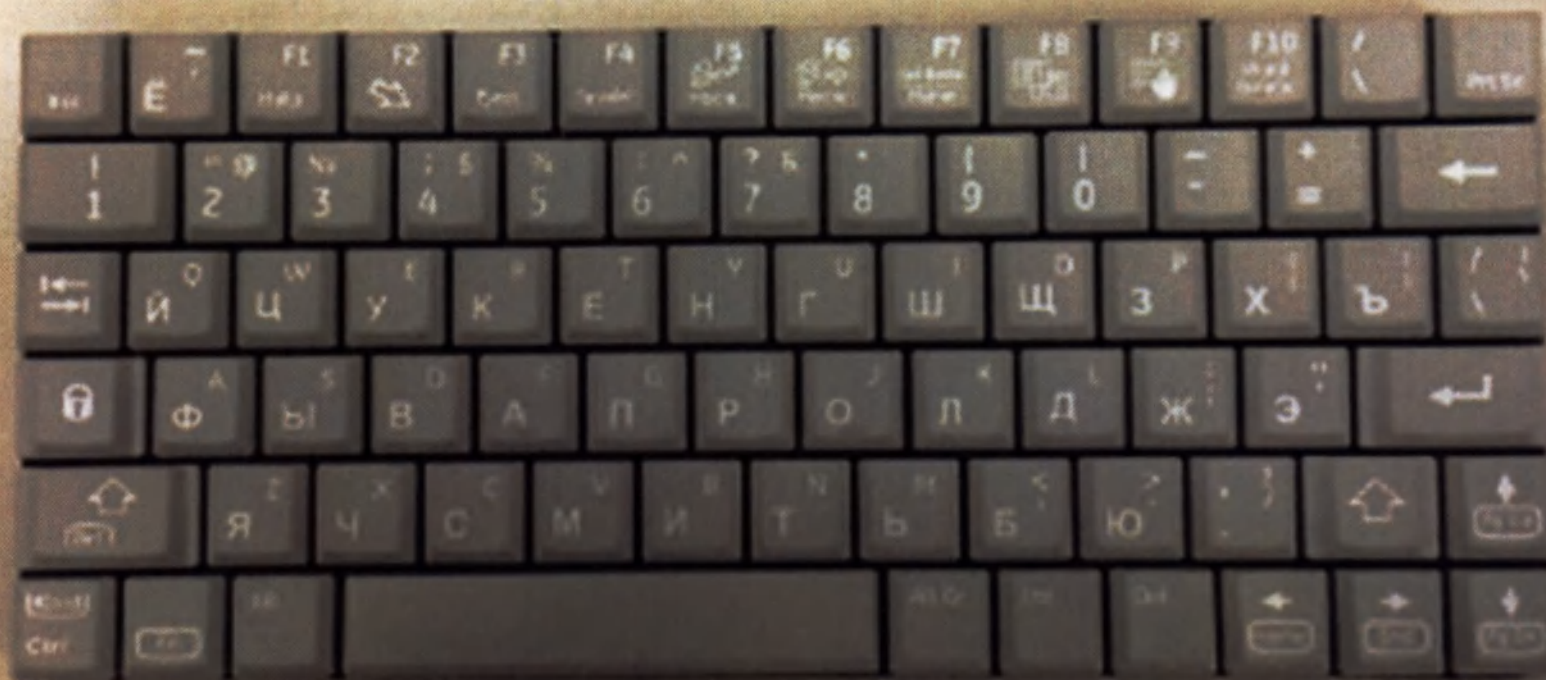

Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)




Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)



Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)



Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)

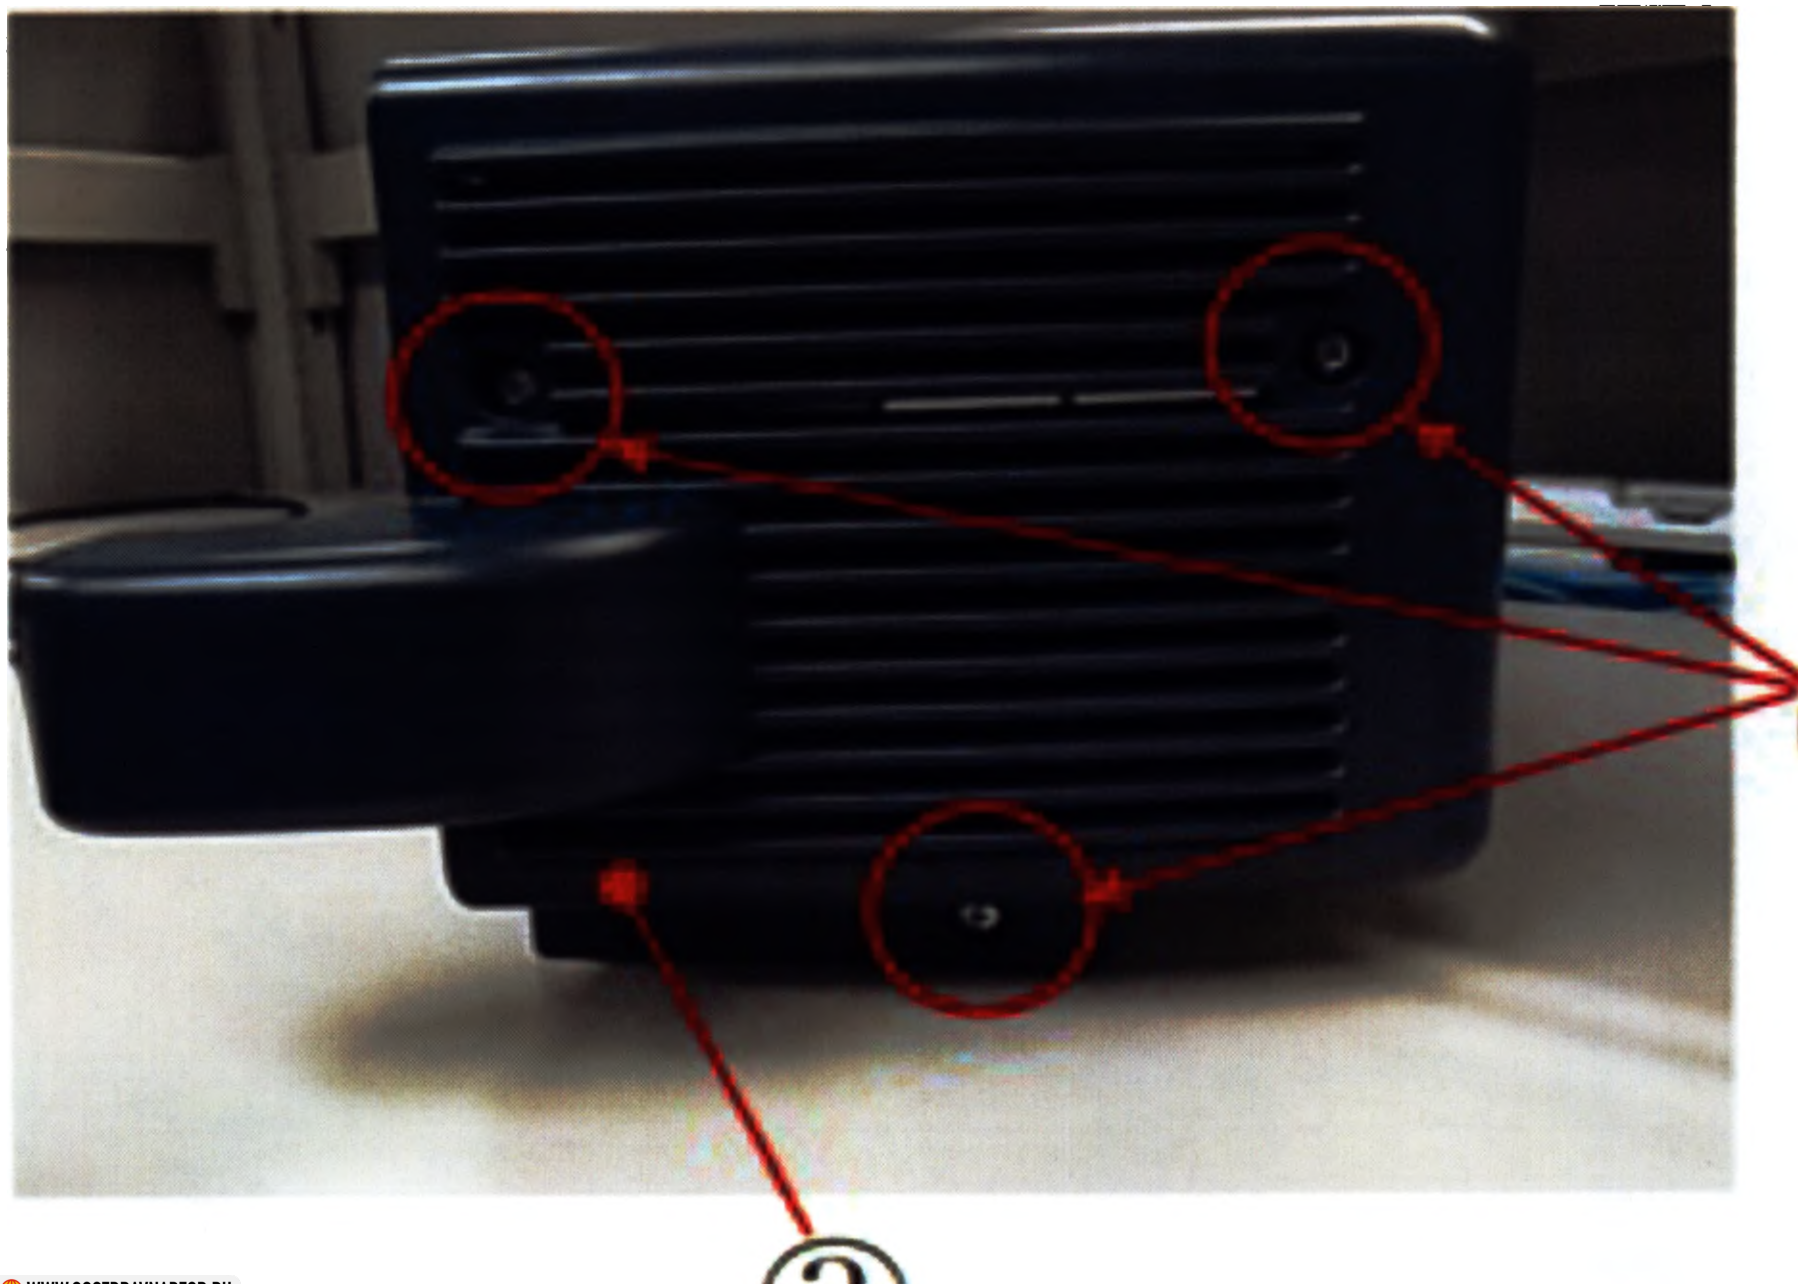

Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)




Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)



Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)




Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)

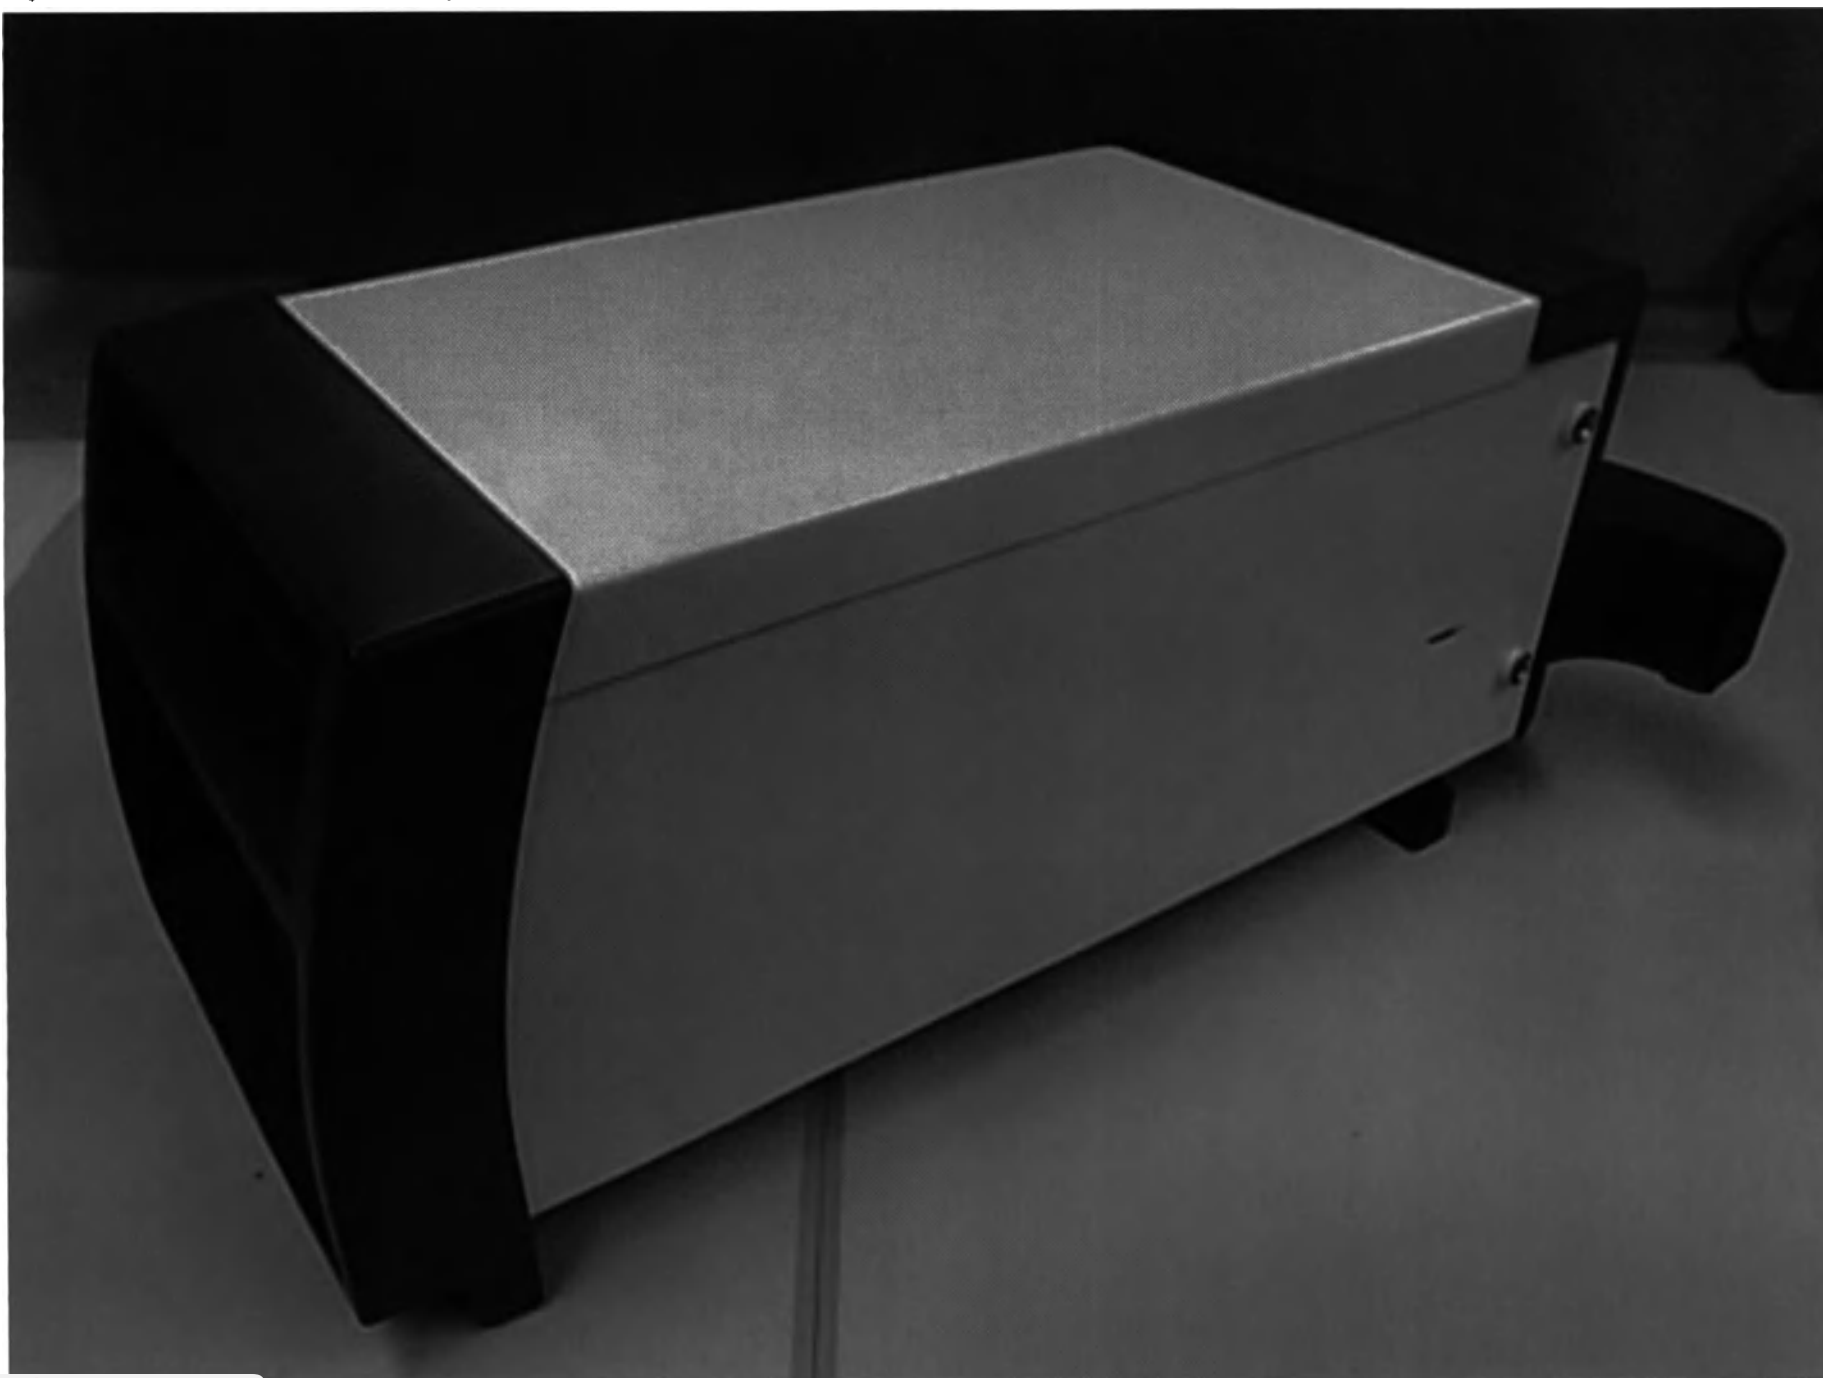


Крышка системного блока. (Версии: R2, R3, R4)




Плата обработки сигналов. (Версии: R2, R3, R4)

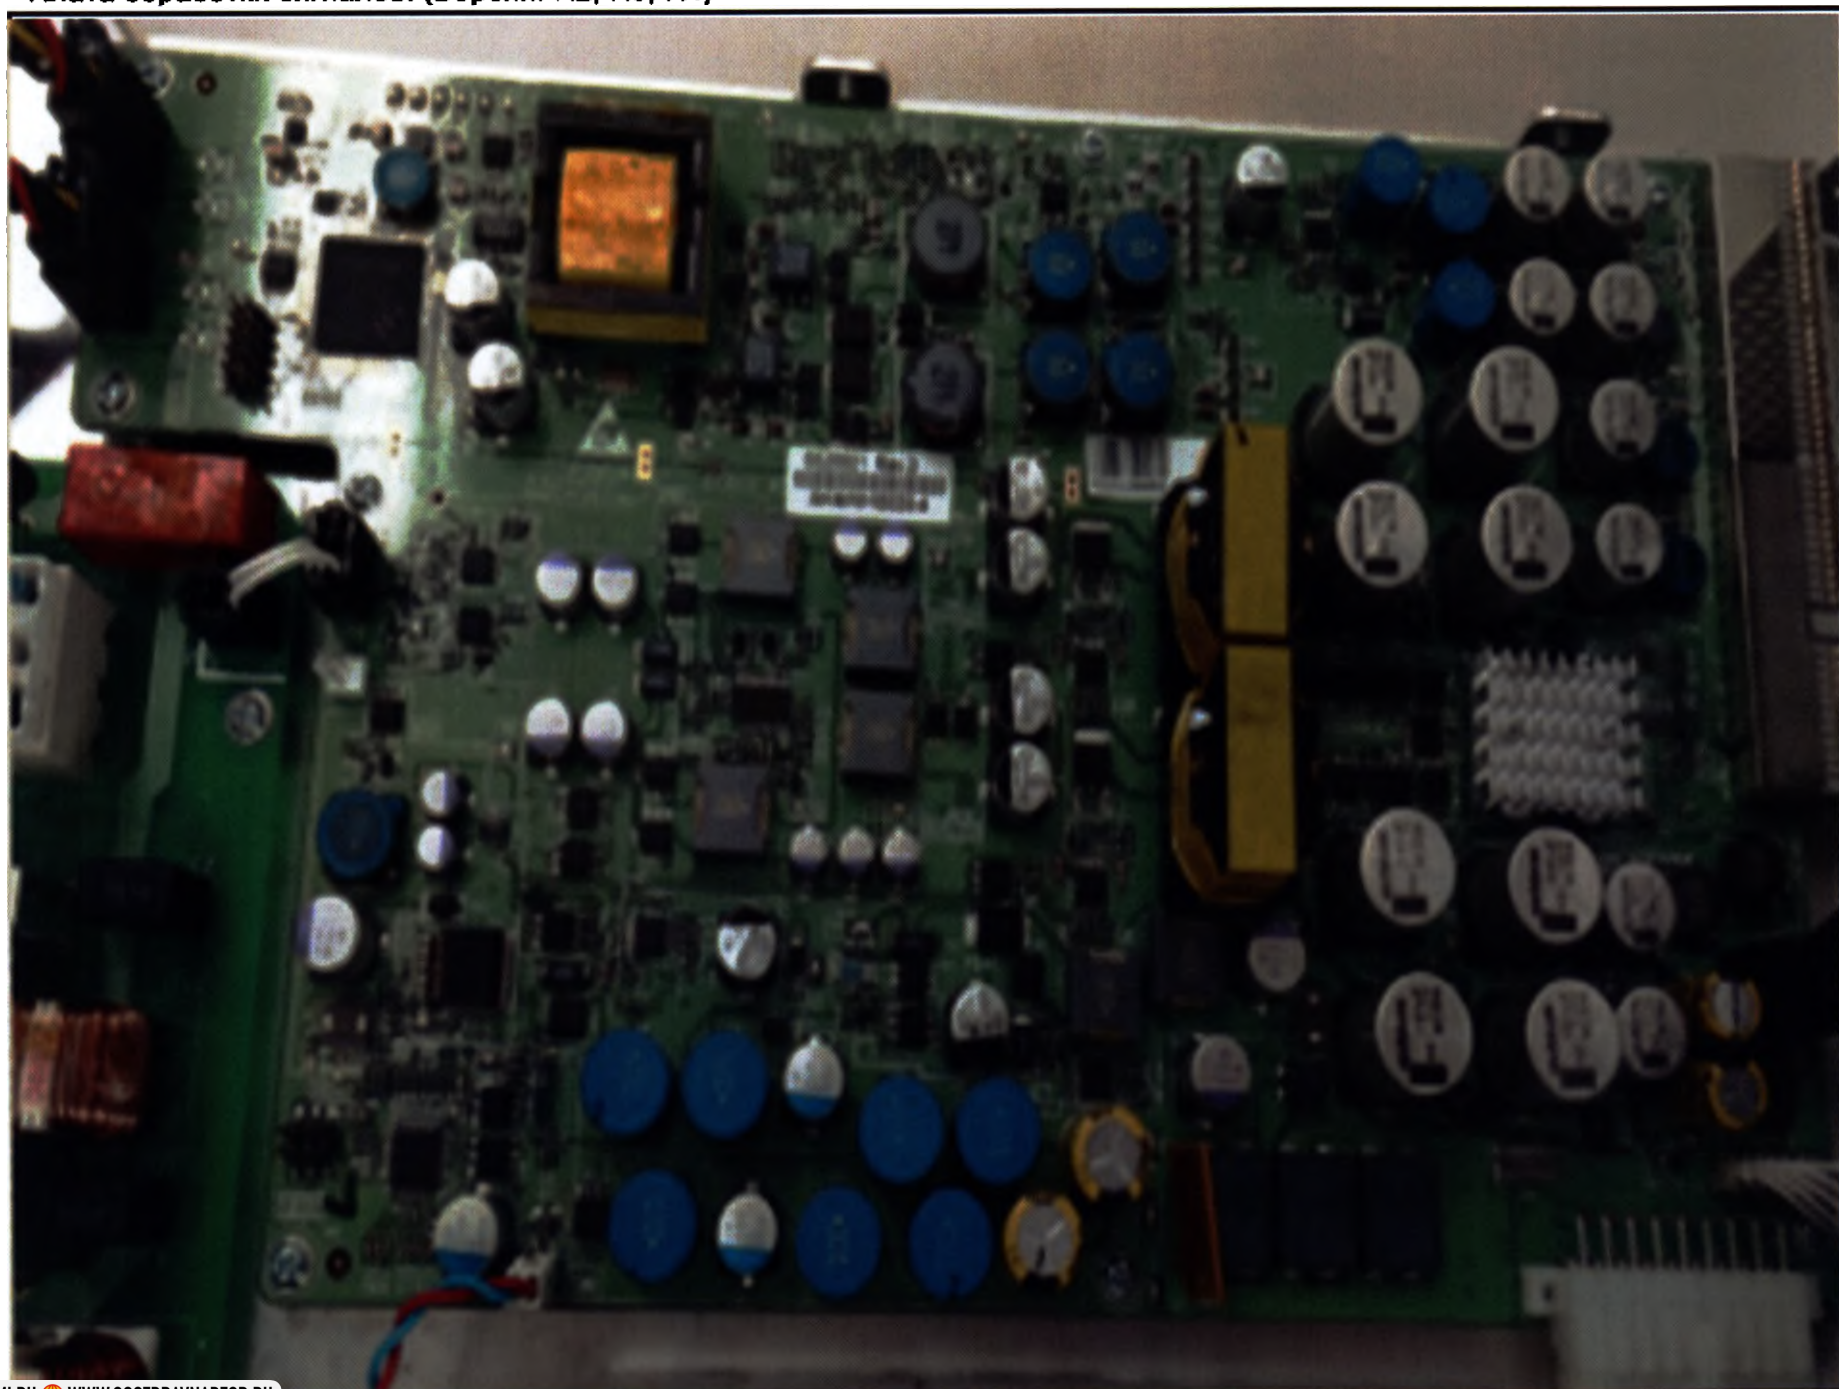


Блок питания (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

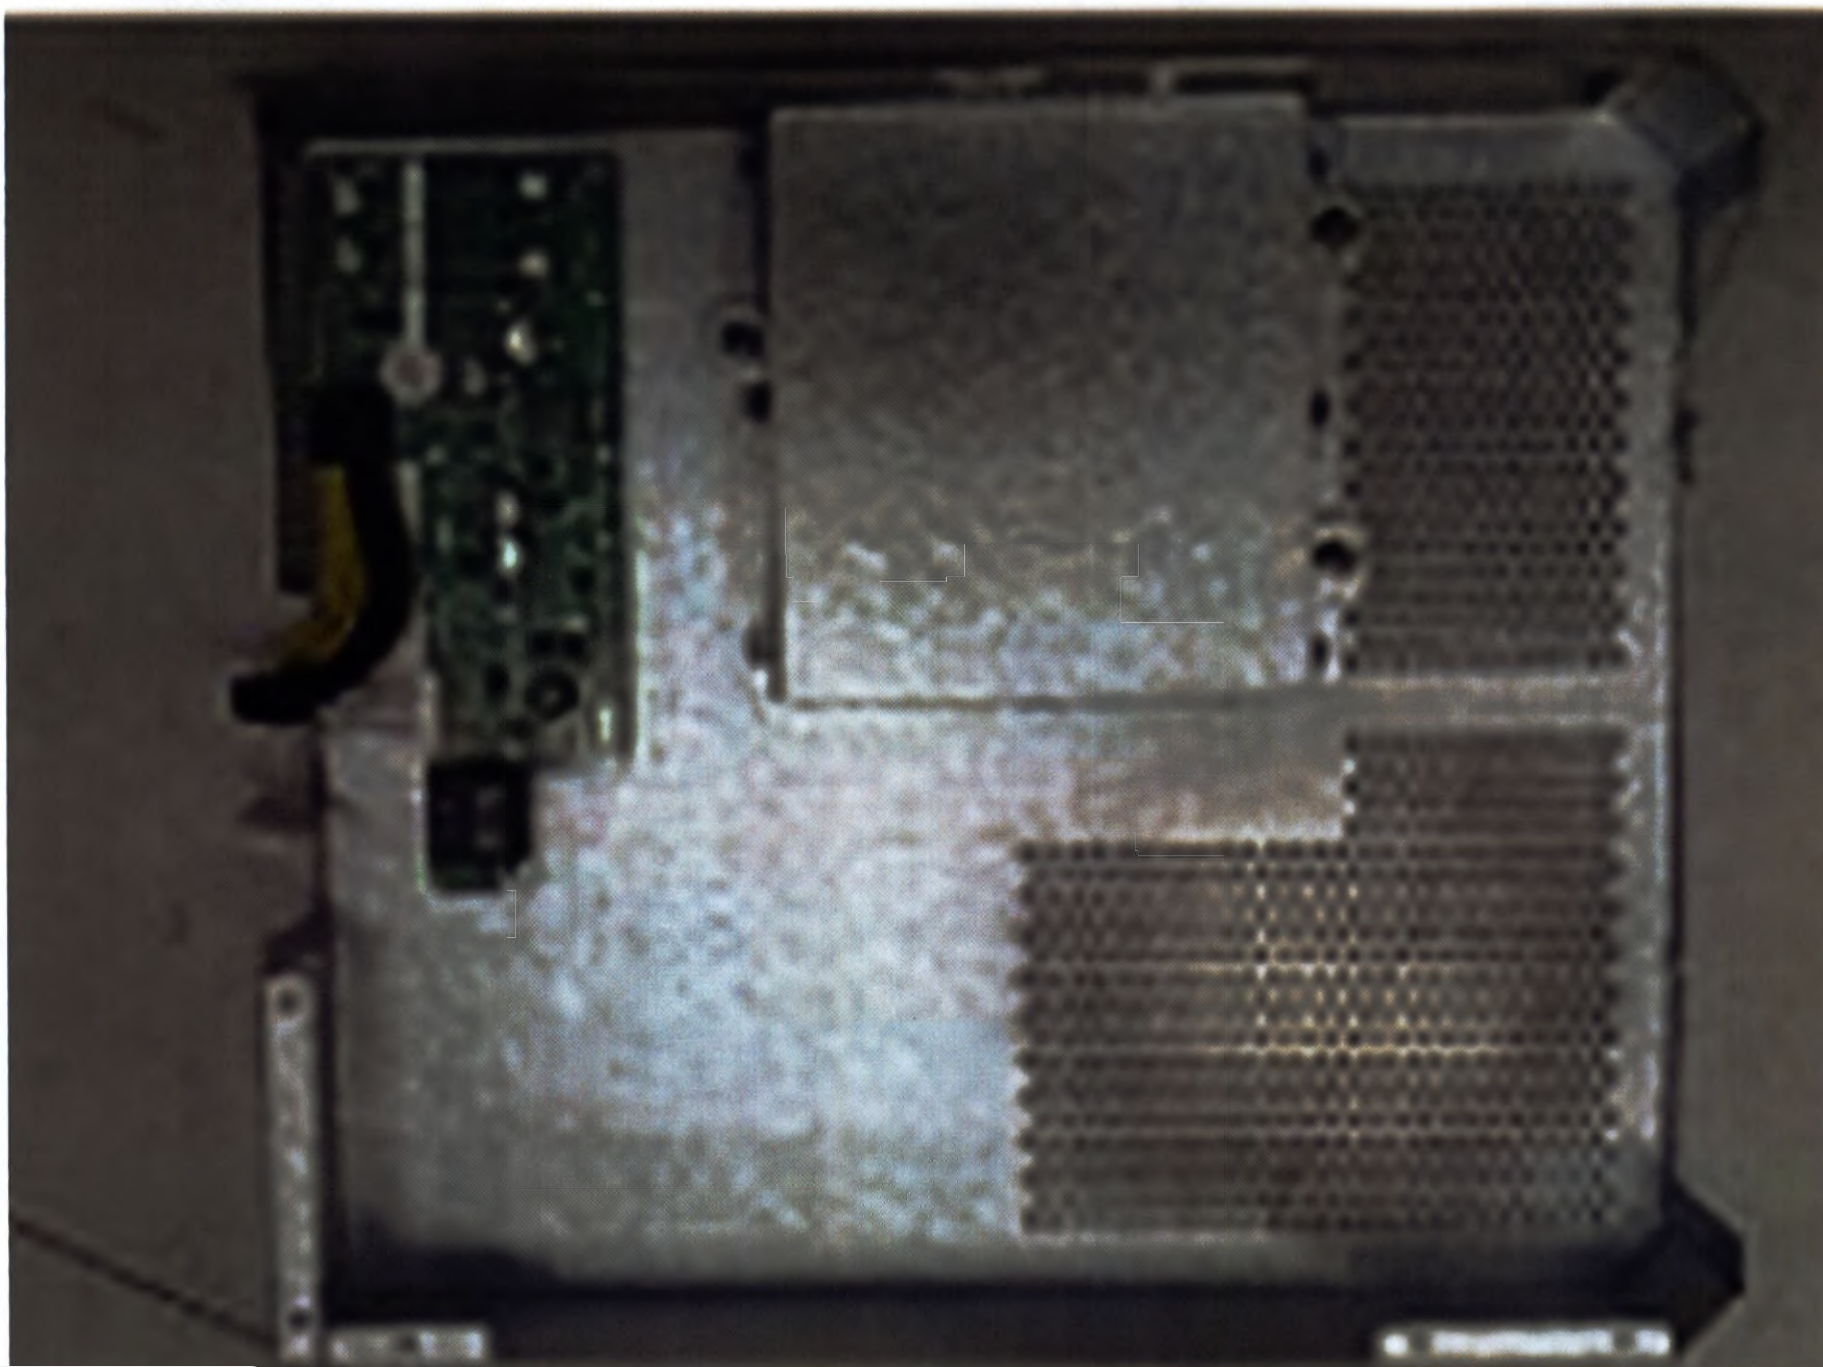

Блок питания (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

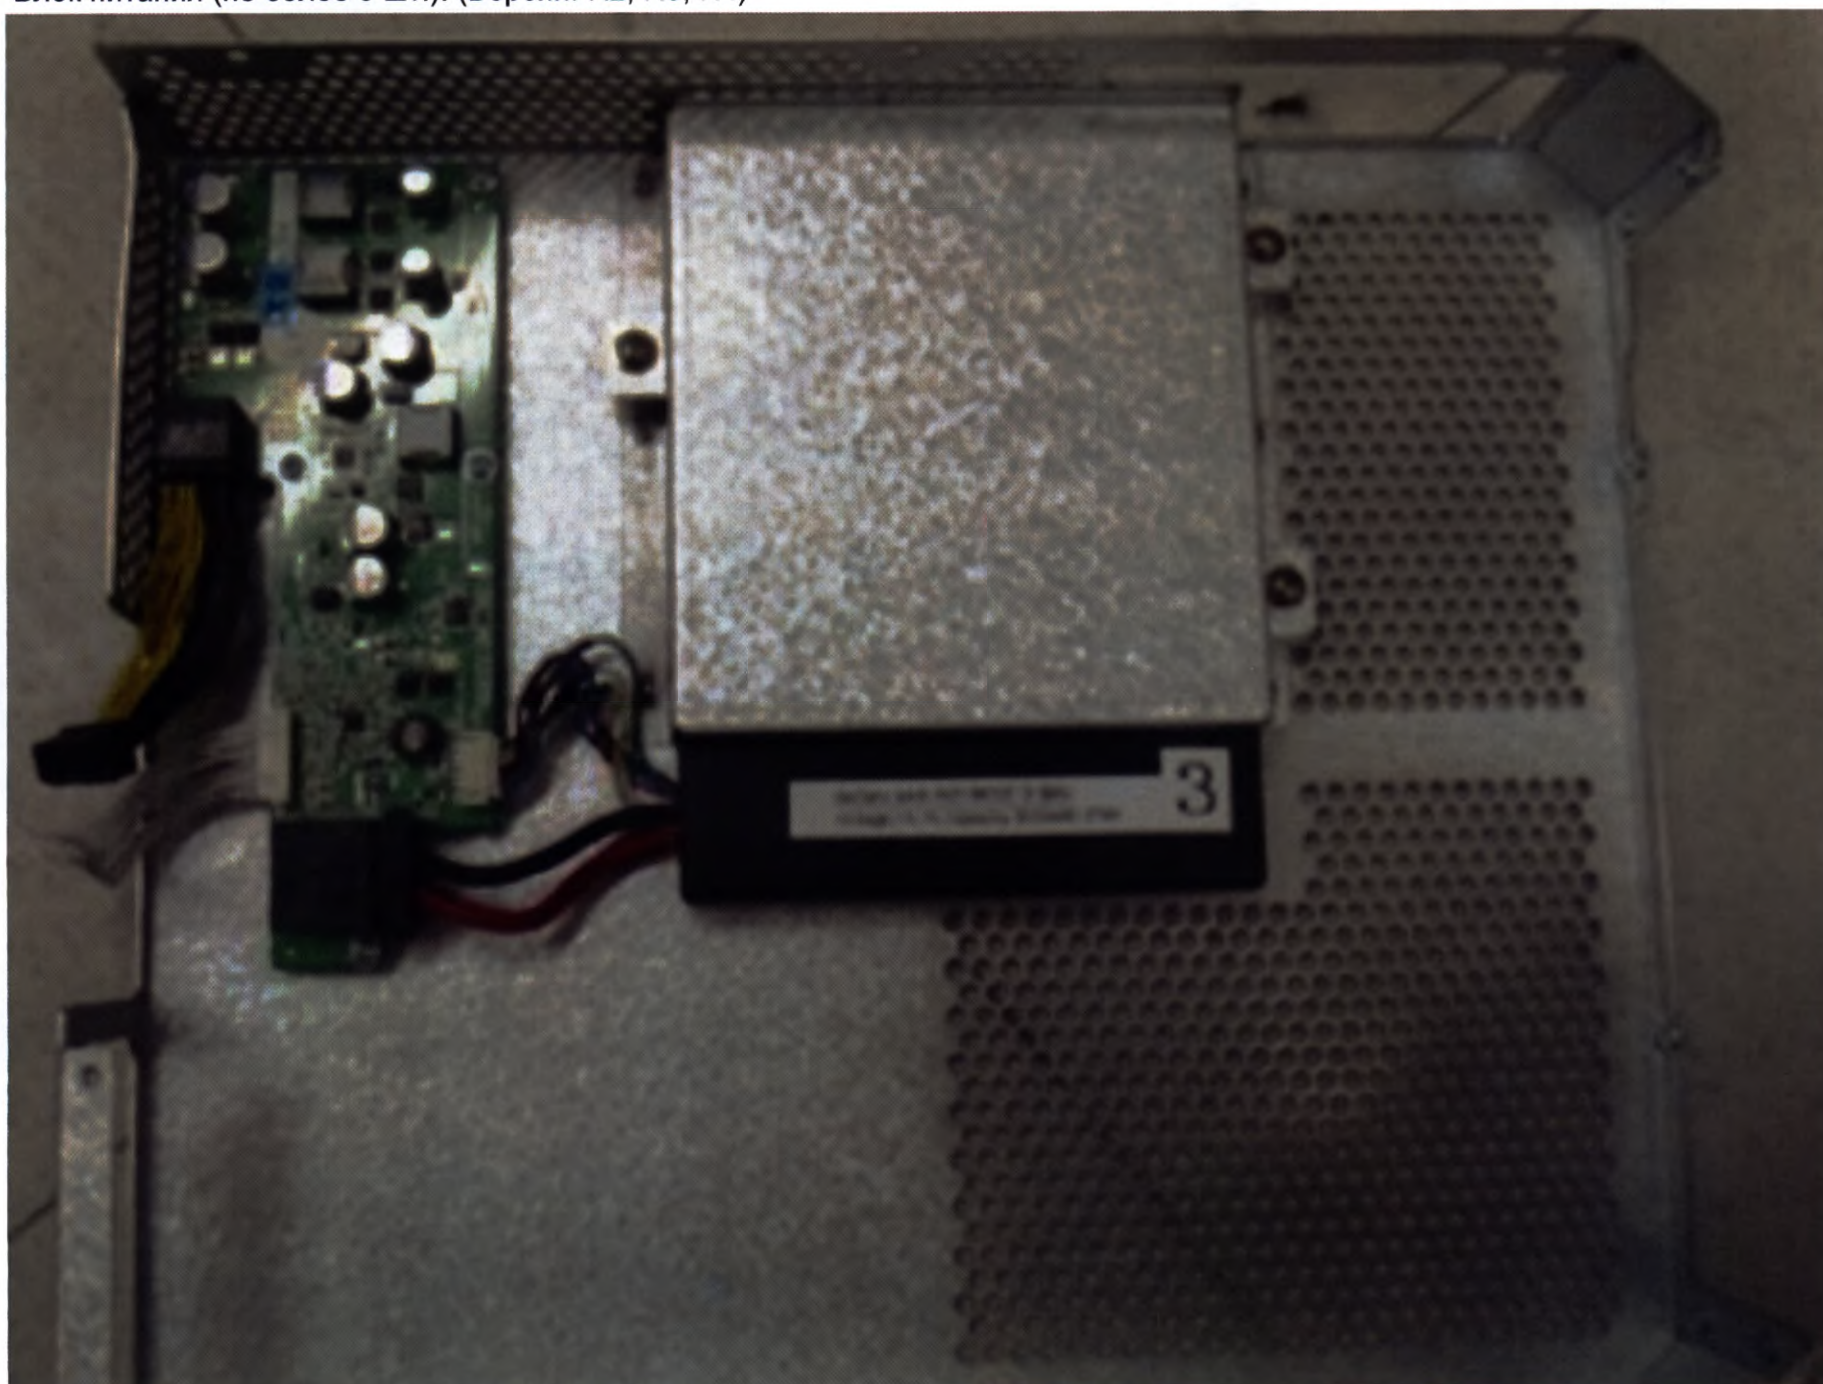


Блок питания (не более 5 шт.). (Версии: R2, R3, R4)

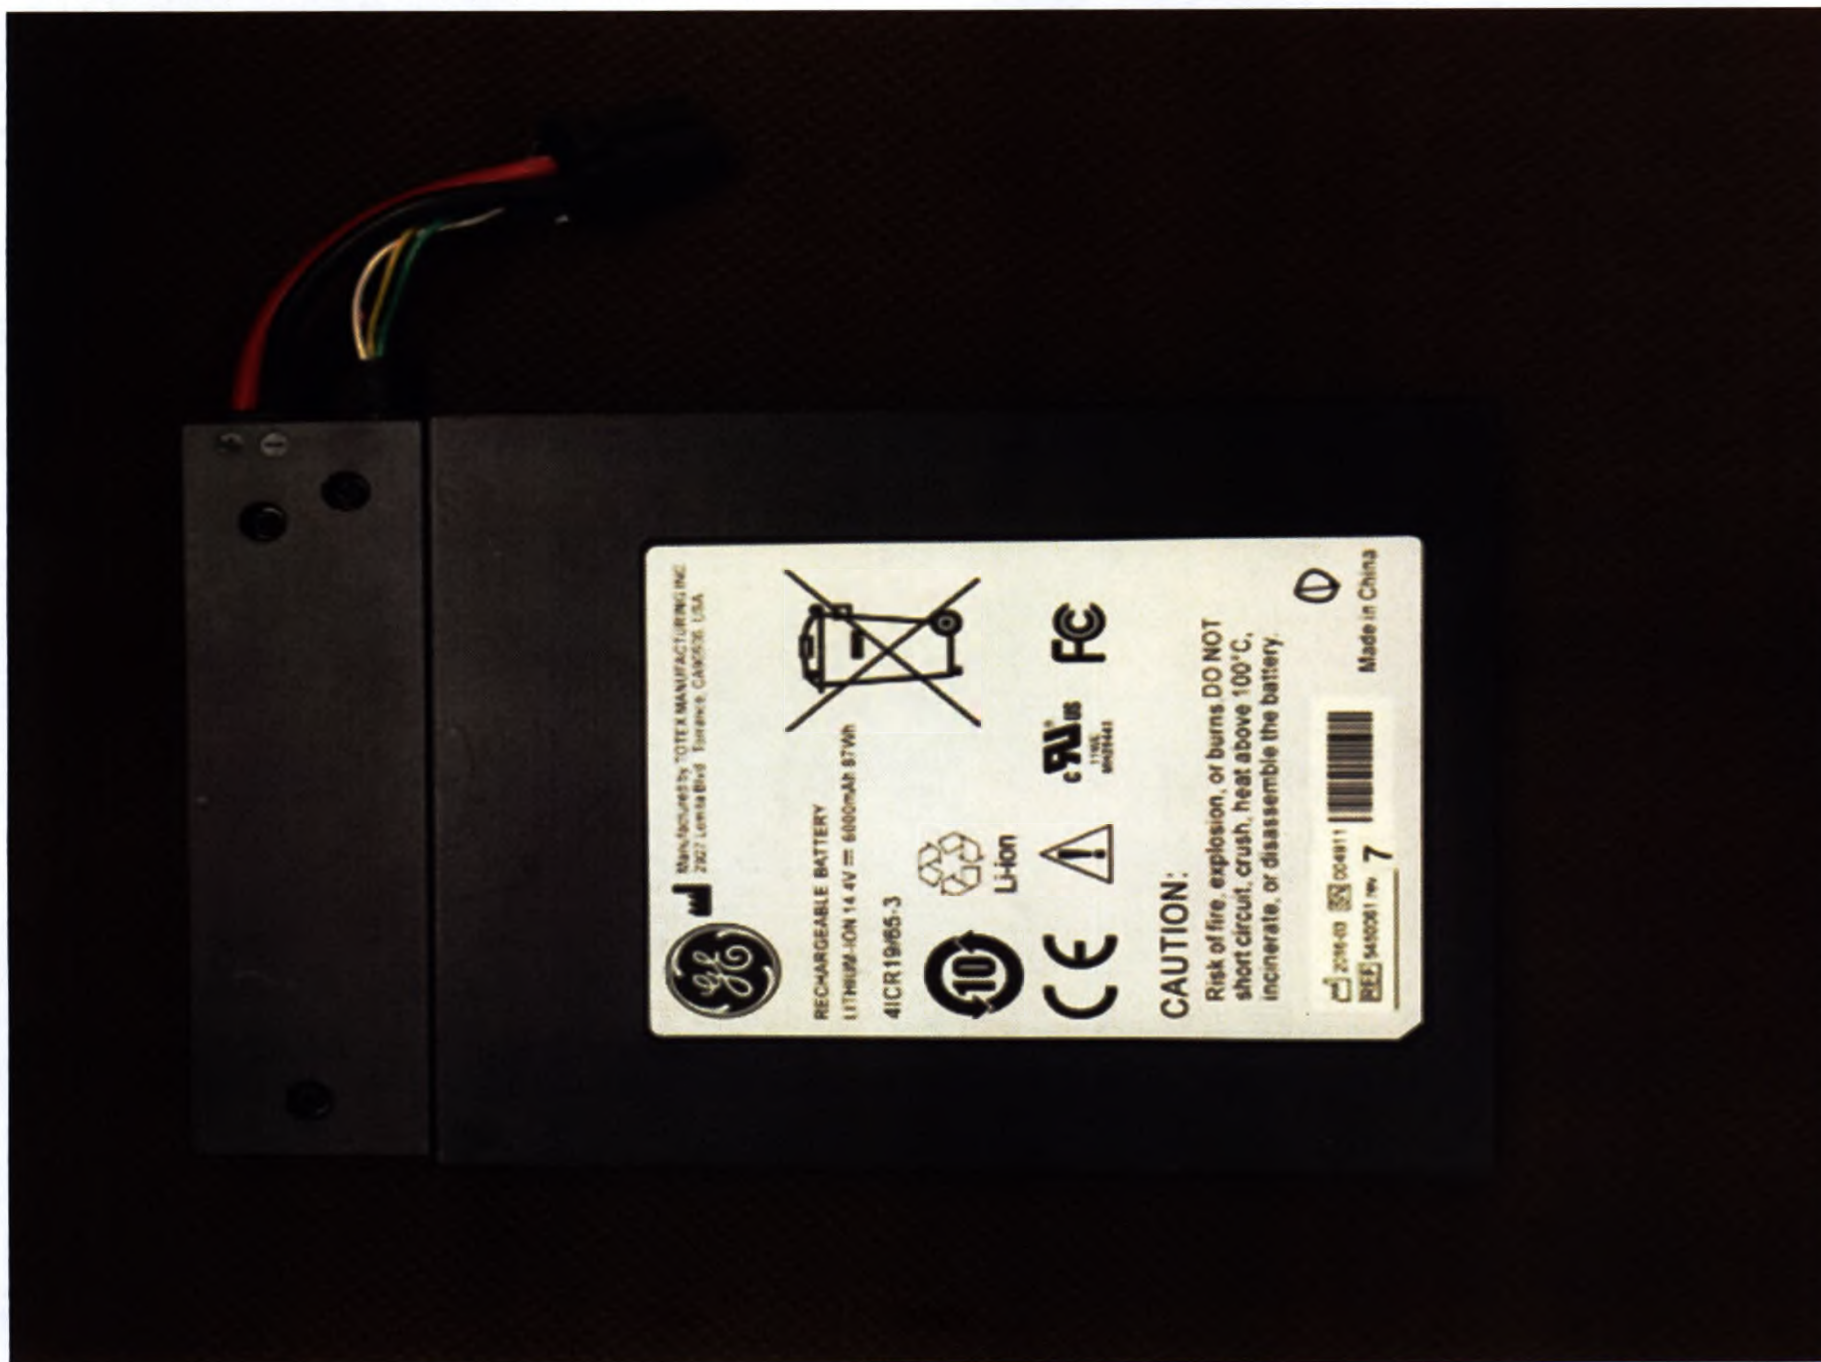


Соединительный кабель. (Версии: R2, R3, R4)




Соединительный кабель. (Версии: R2, R3, R4)

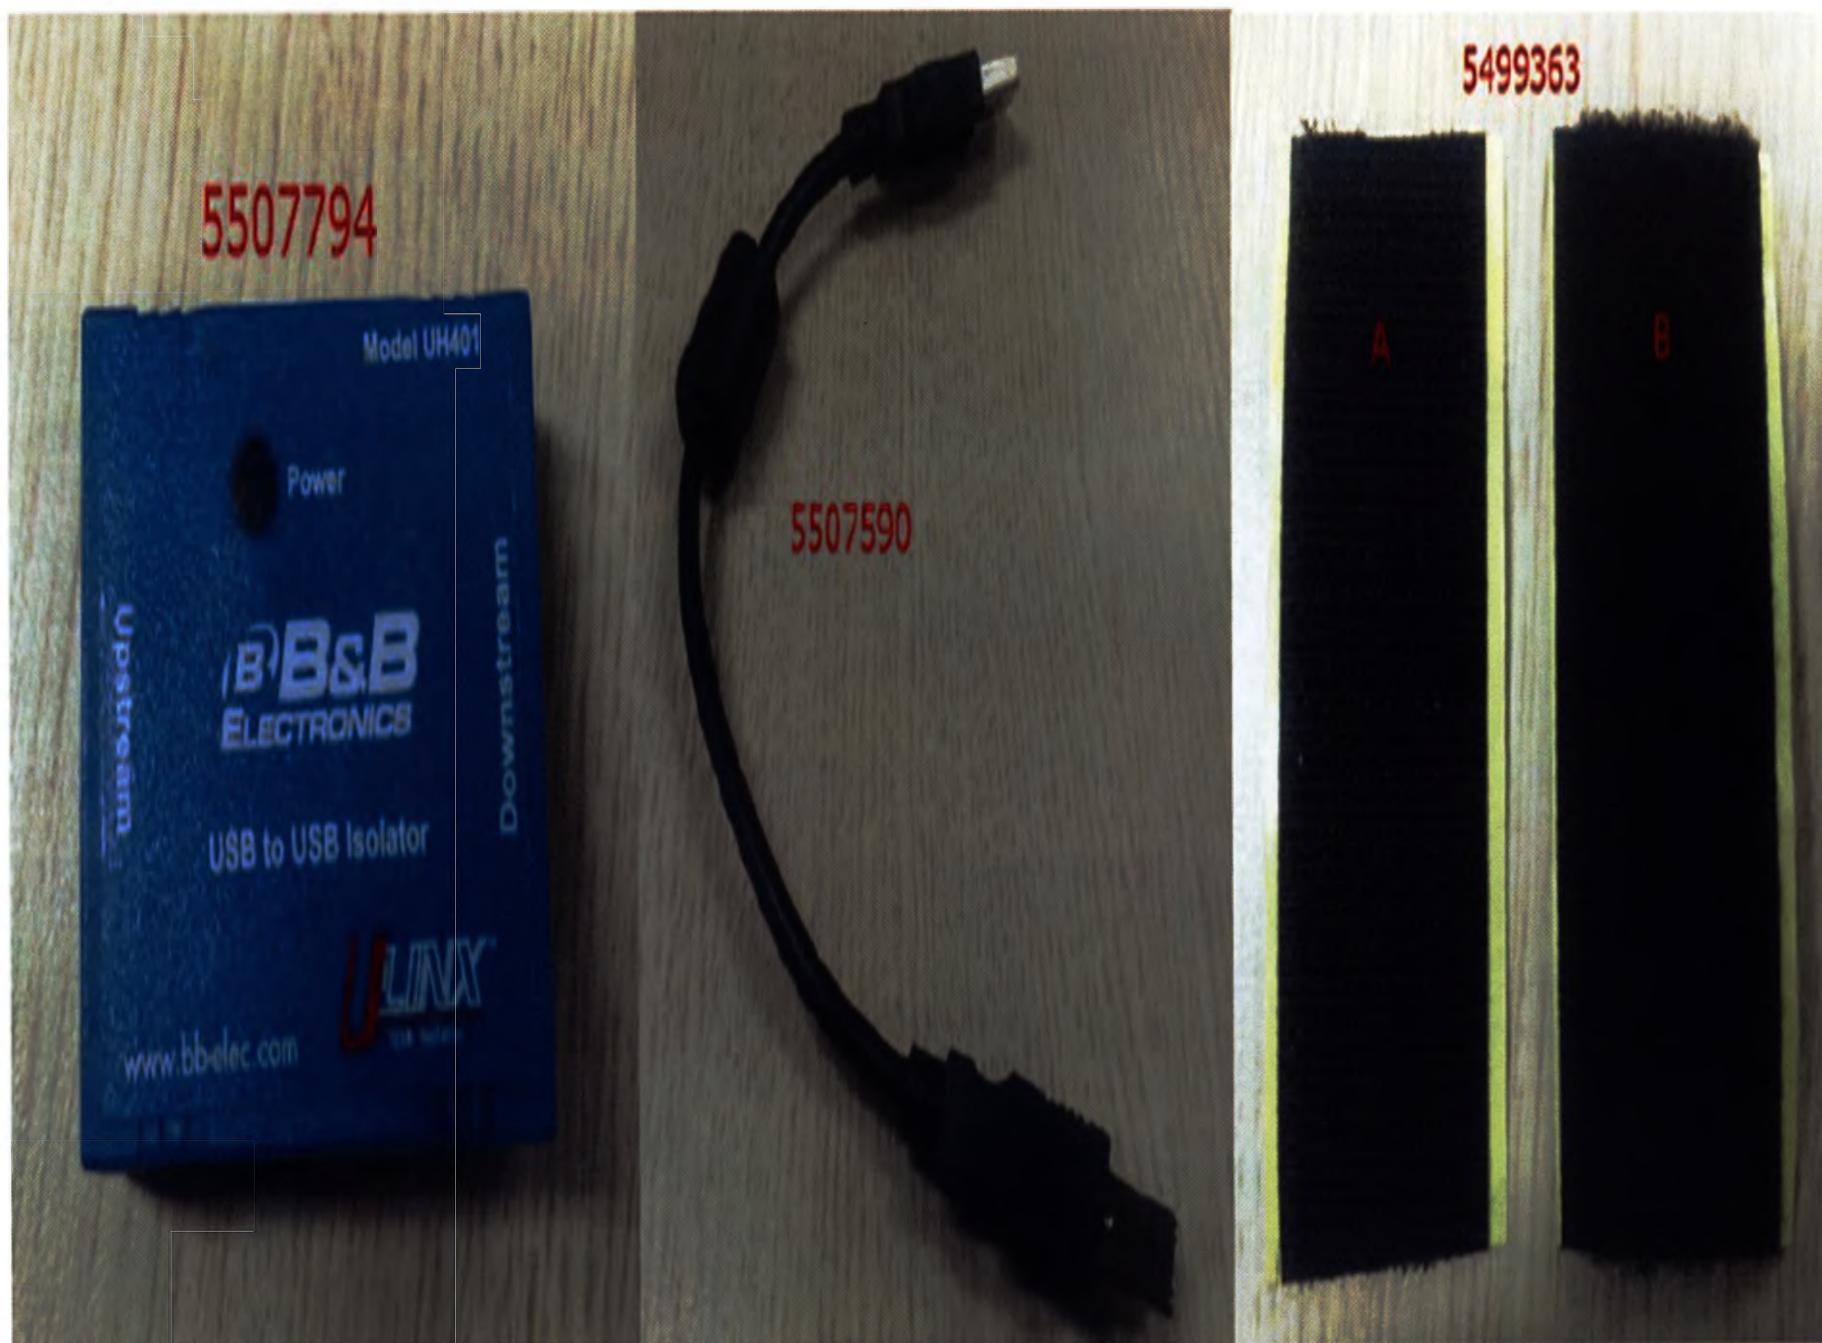

Коммутационная плата. (Версии: R2, R3, R4)

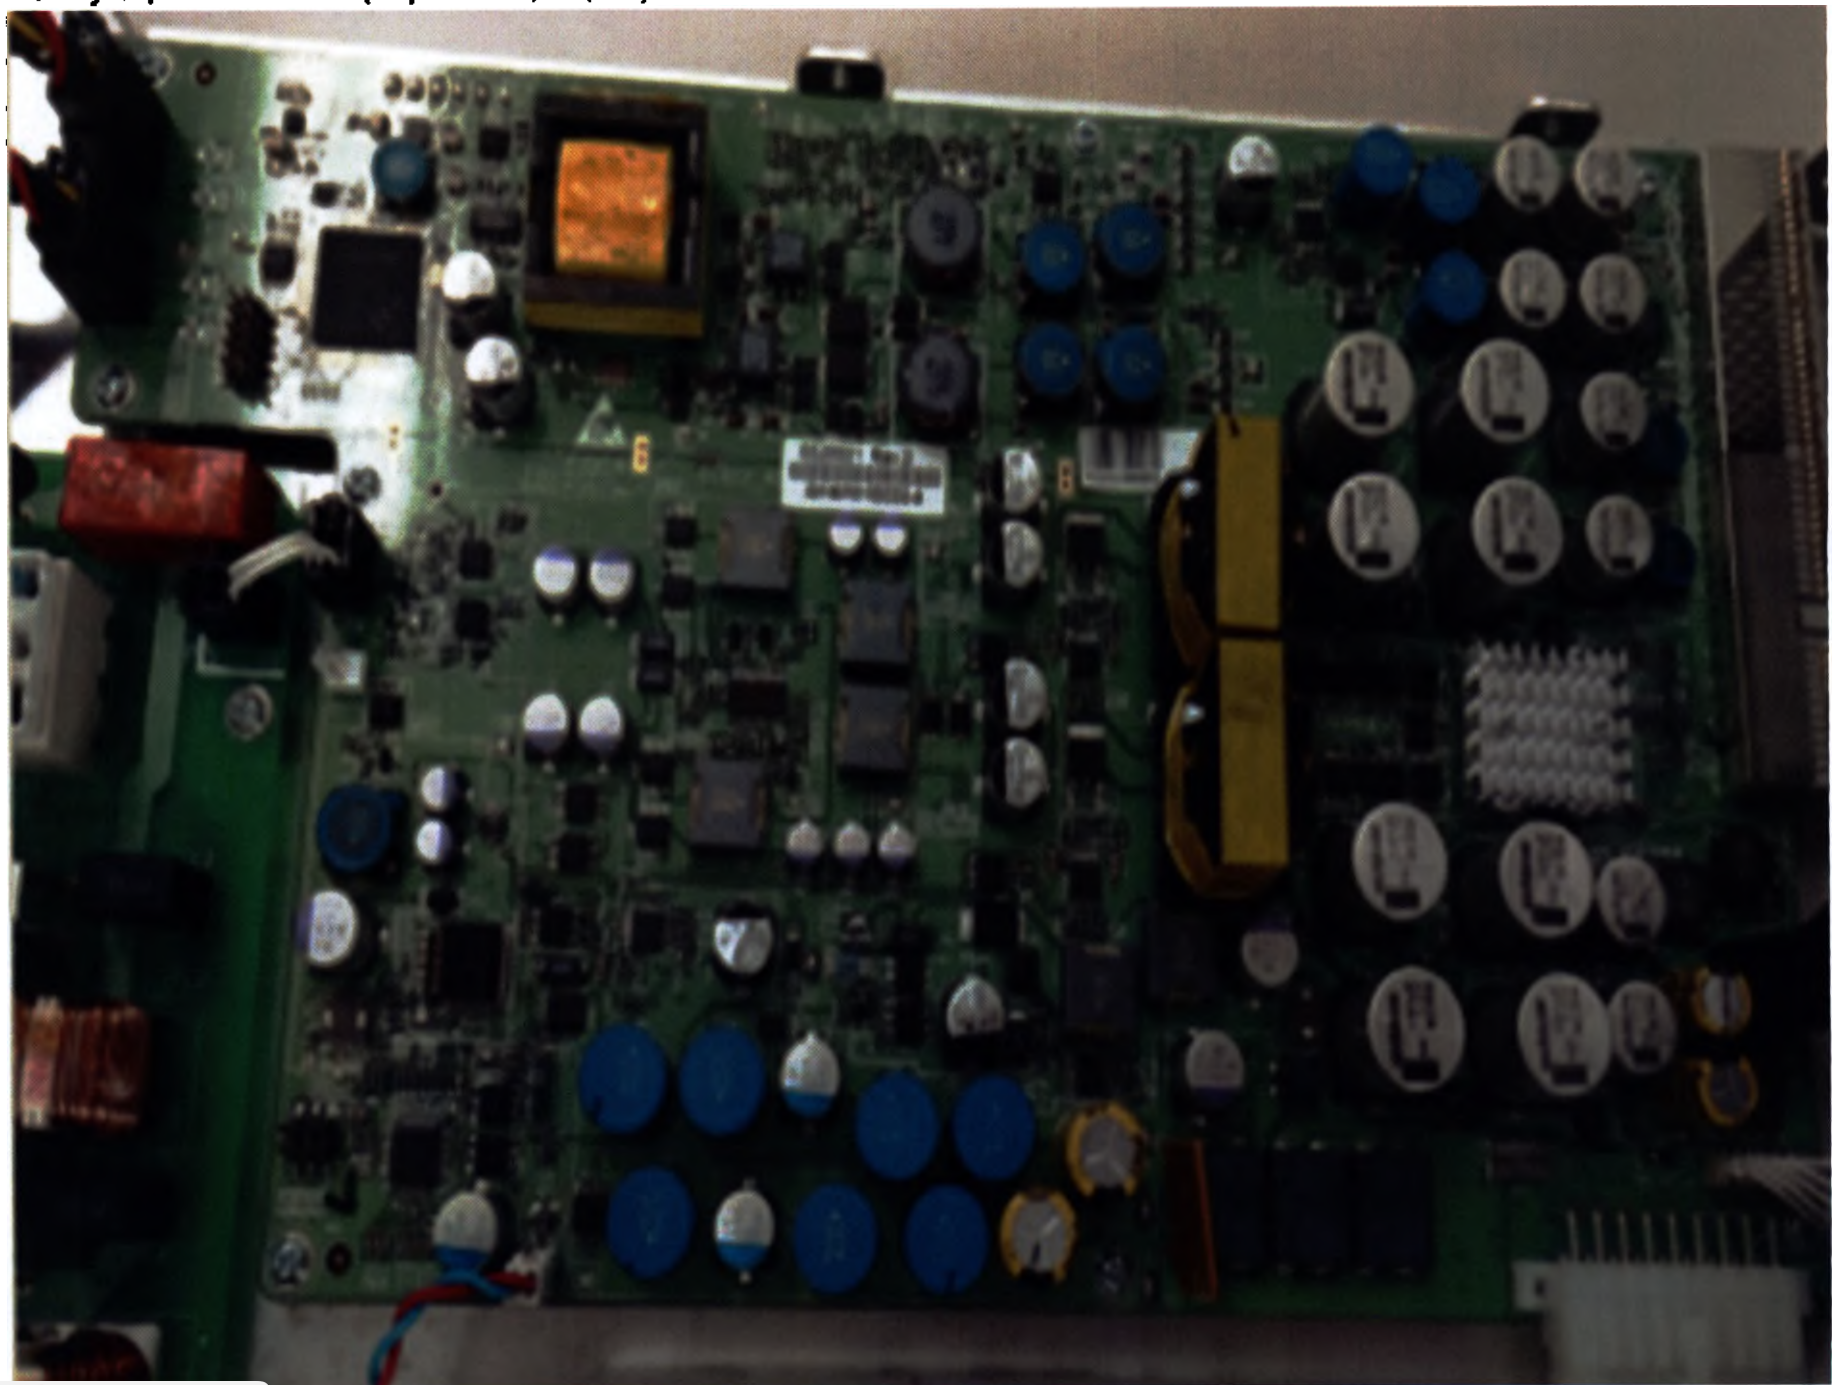


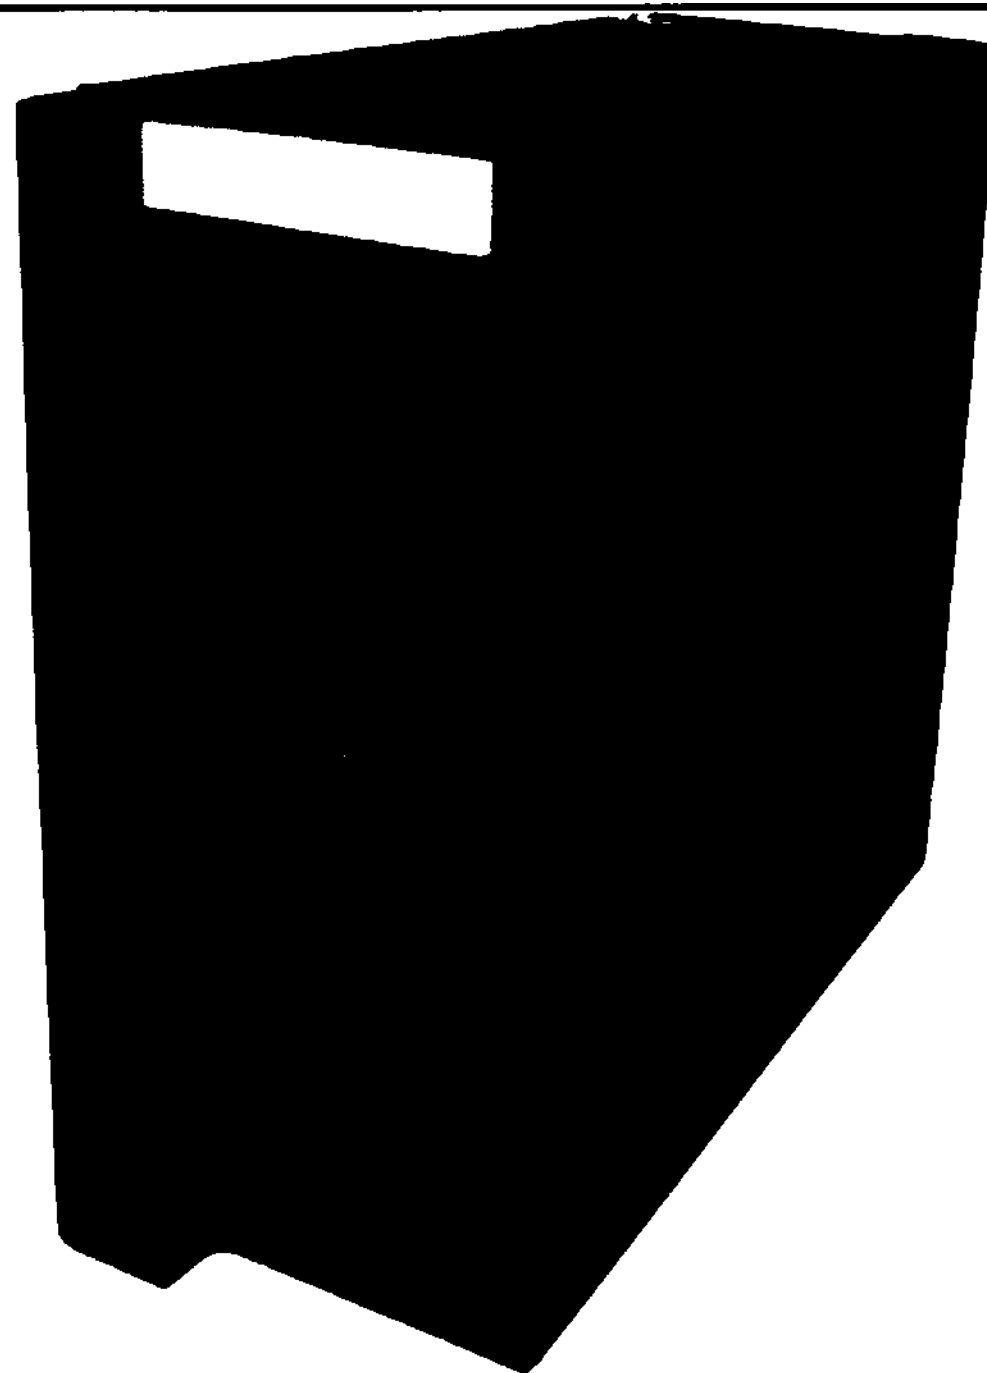

Разъемы для подключения датчиков. (Версии: R2, R3, R4)



Шаровый манипулятор. (Версии: R2, R3, R4)

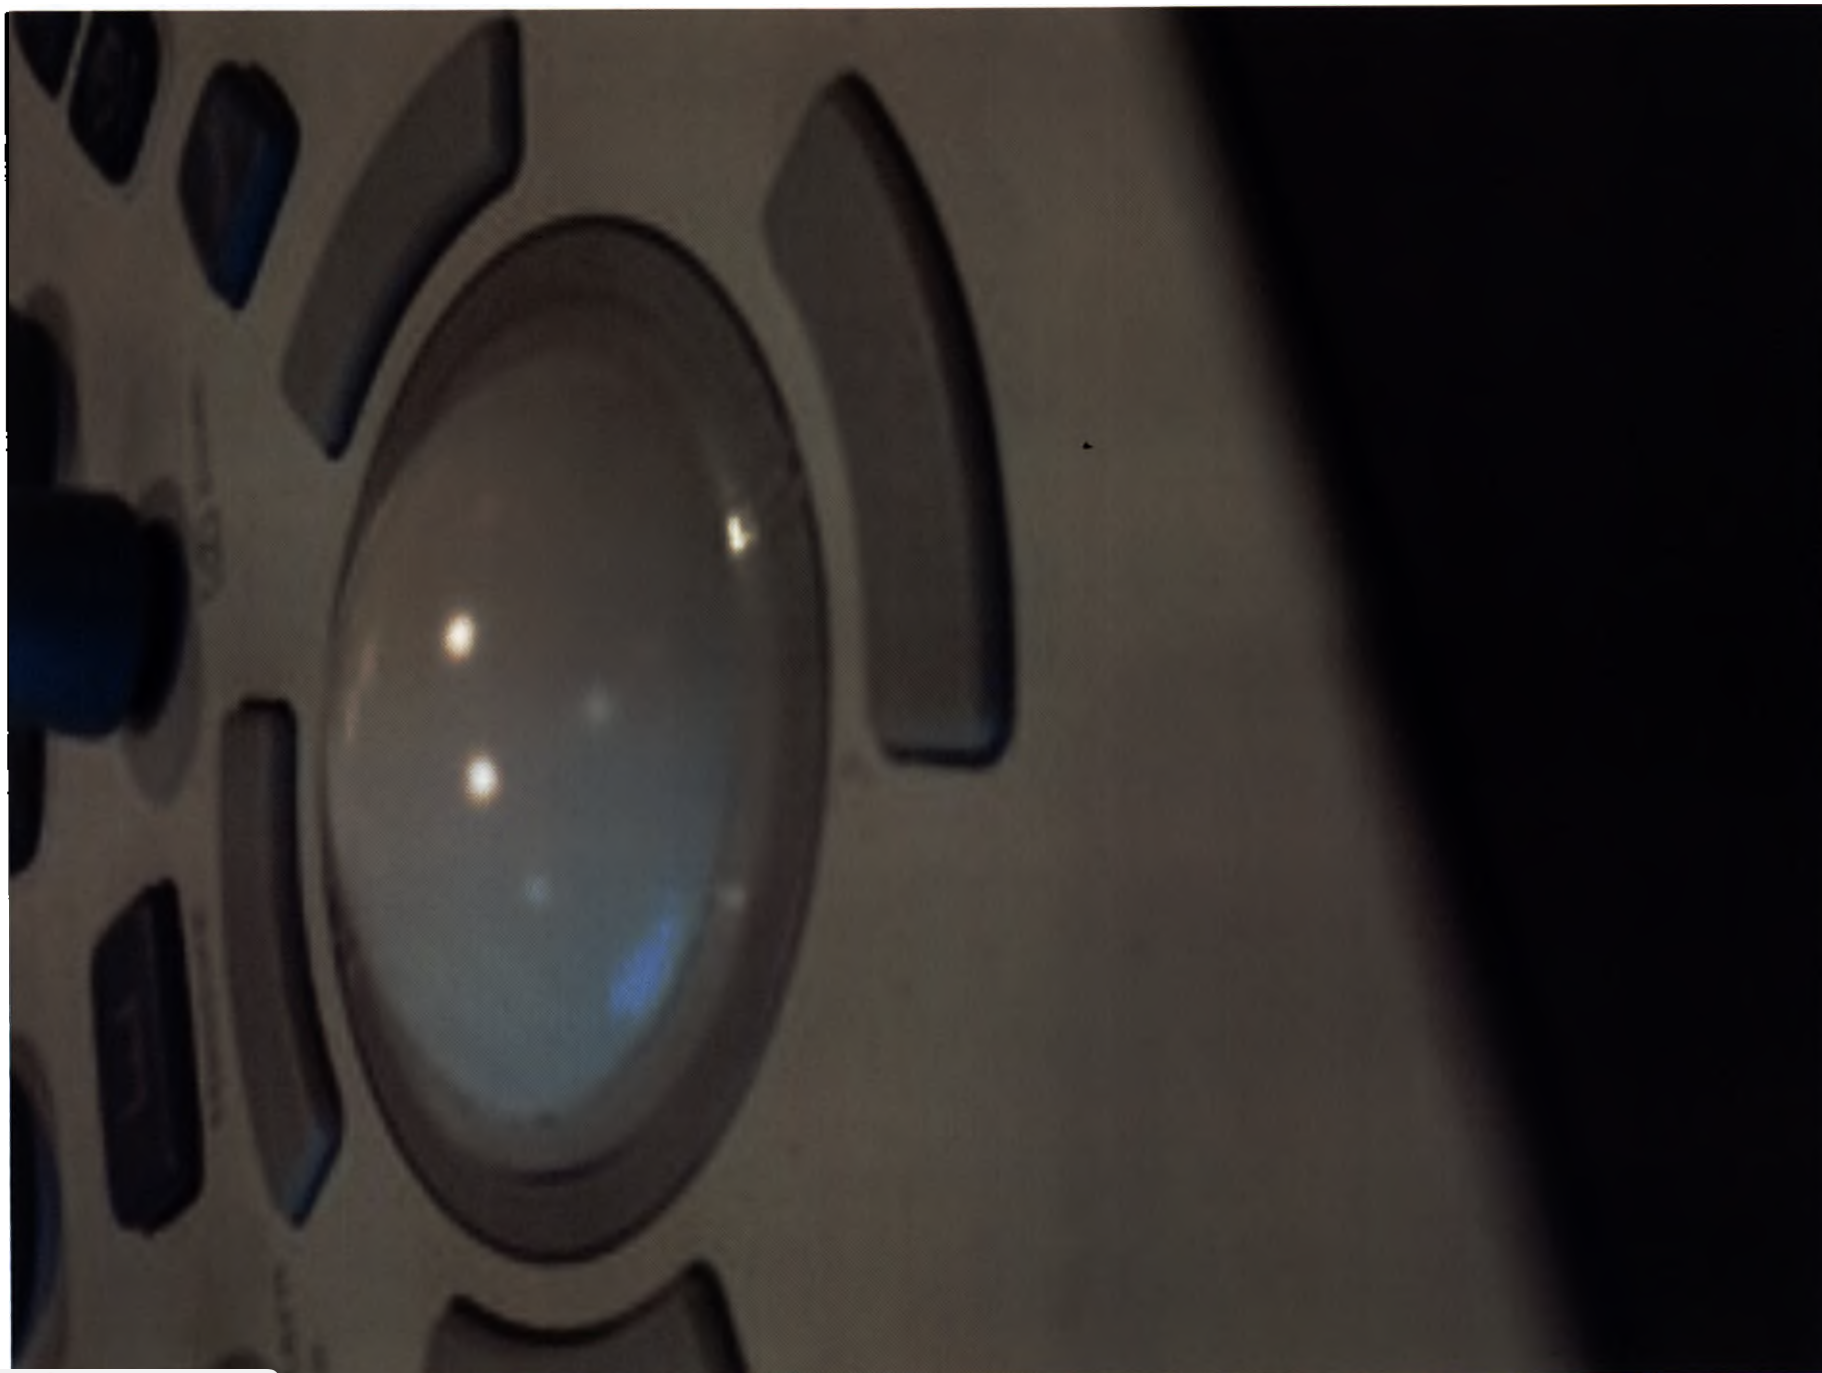



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме STIC. (Версии: R4)





Модуль для неинвазивного определения степени фиброза печени. (Версии: R4)



Датчики ультразвуковые М+ (не более 5 шт.). (Версии: R4)



Датчики ультразвуковые XL+ (не более 5 шт.). (Версии: R4)







Программный модуль для поддержки датчиков со встроенными трекерами. (Версии: R4)



Модуль для поддержки аккумуляторных батарей. (Версии: R4)

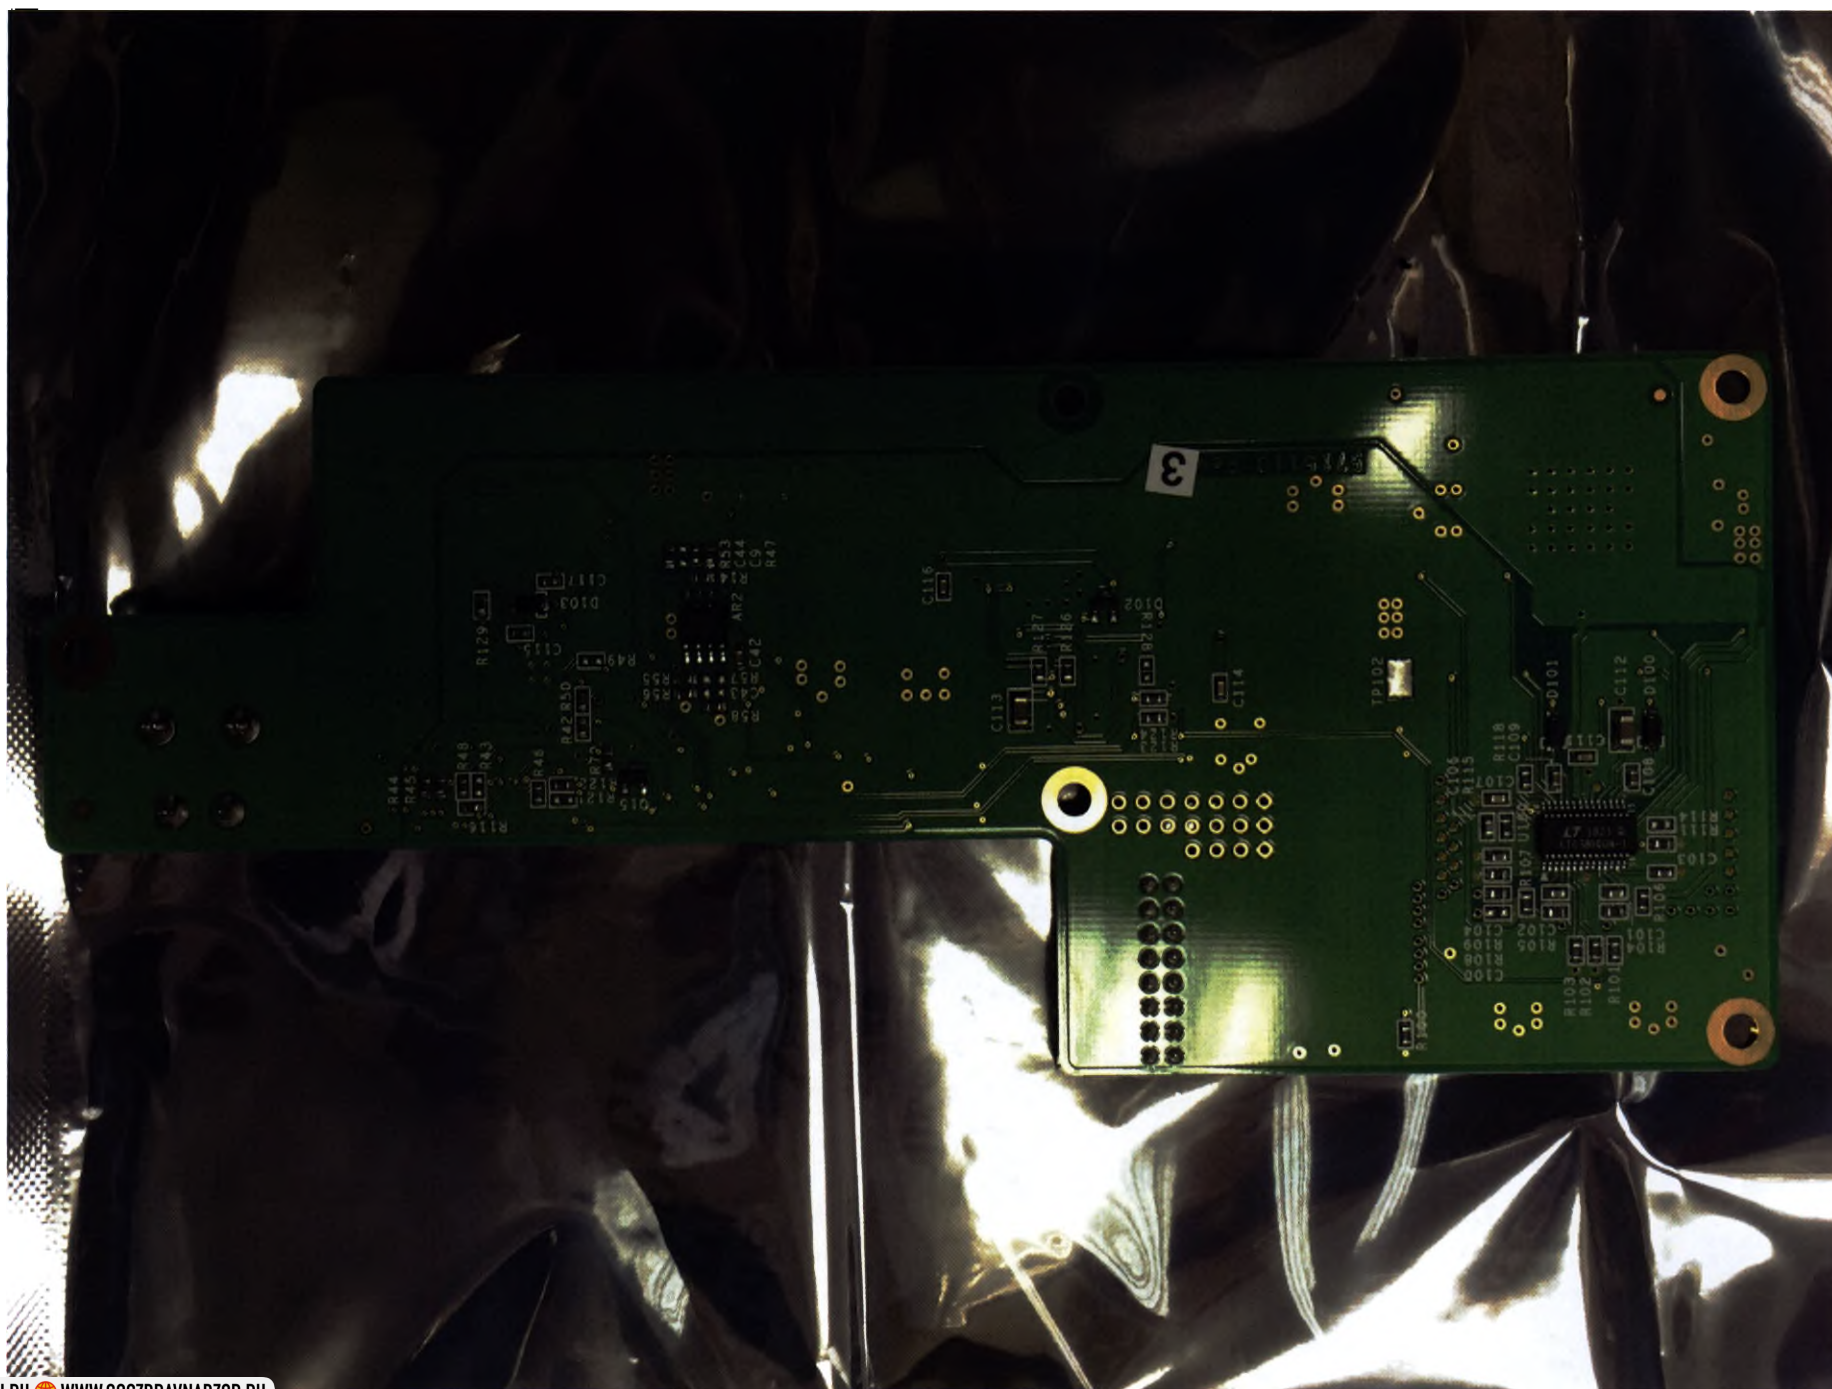


Аккумуляторные батареи (не более 5 шт.). (Версии: R4)

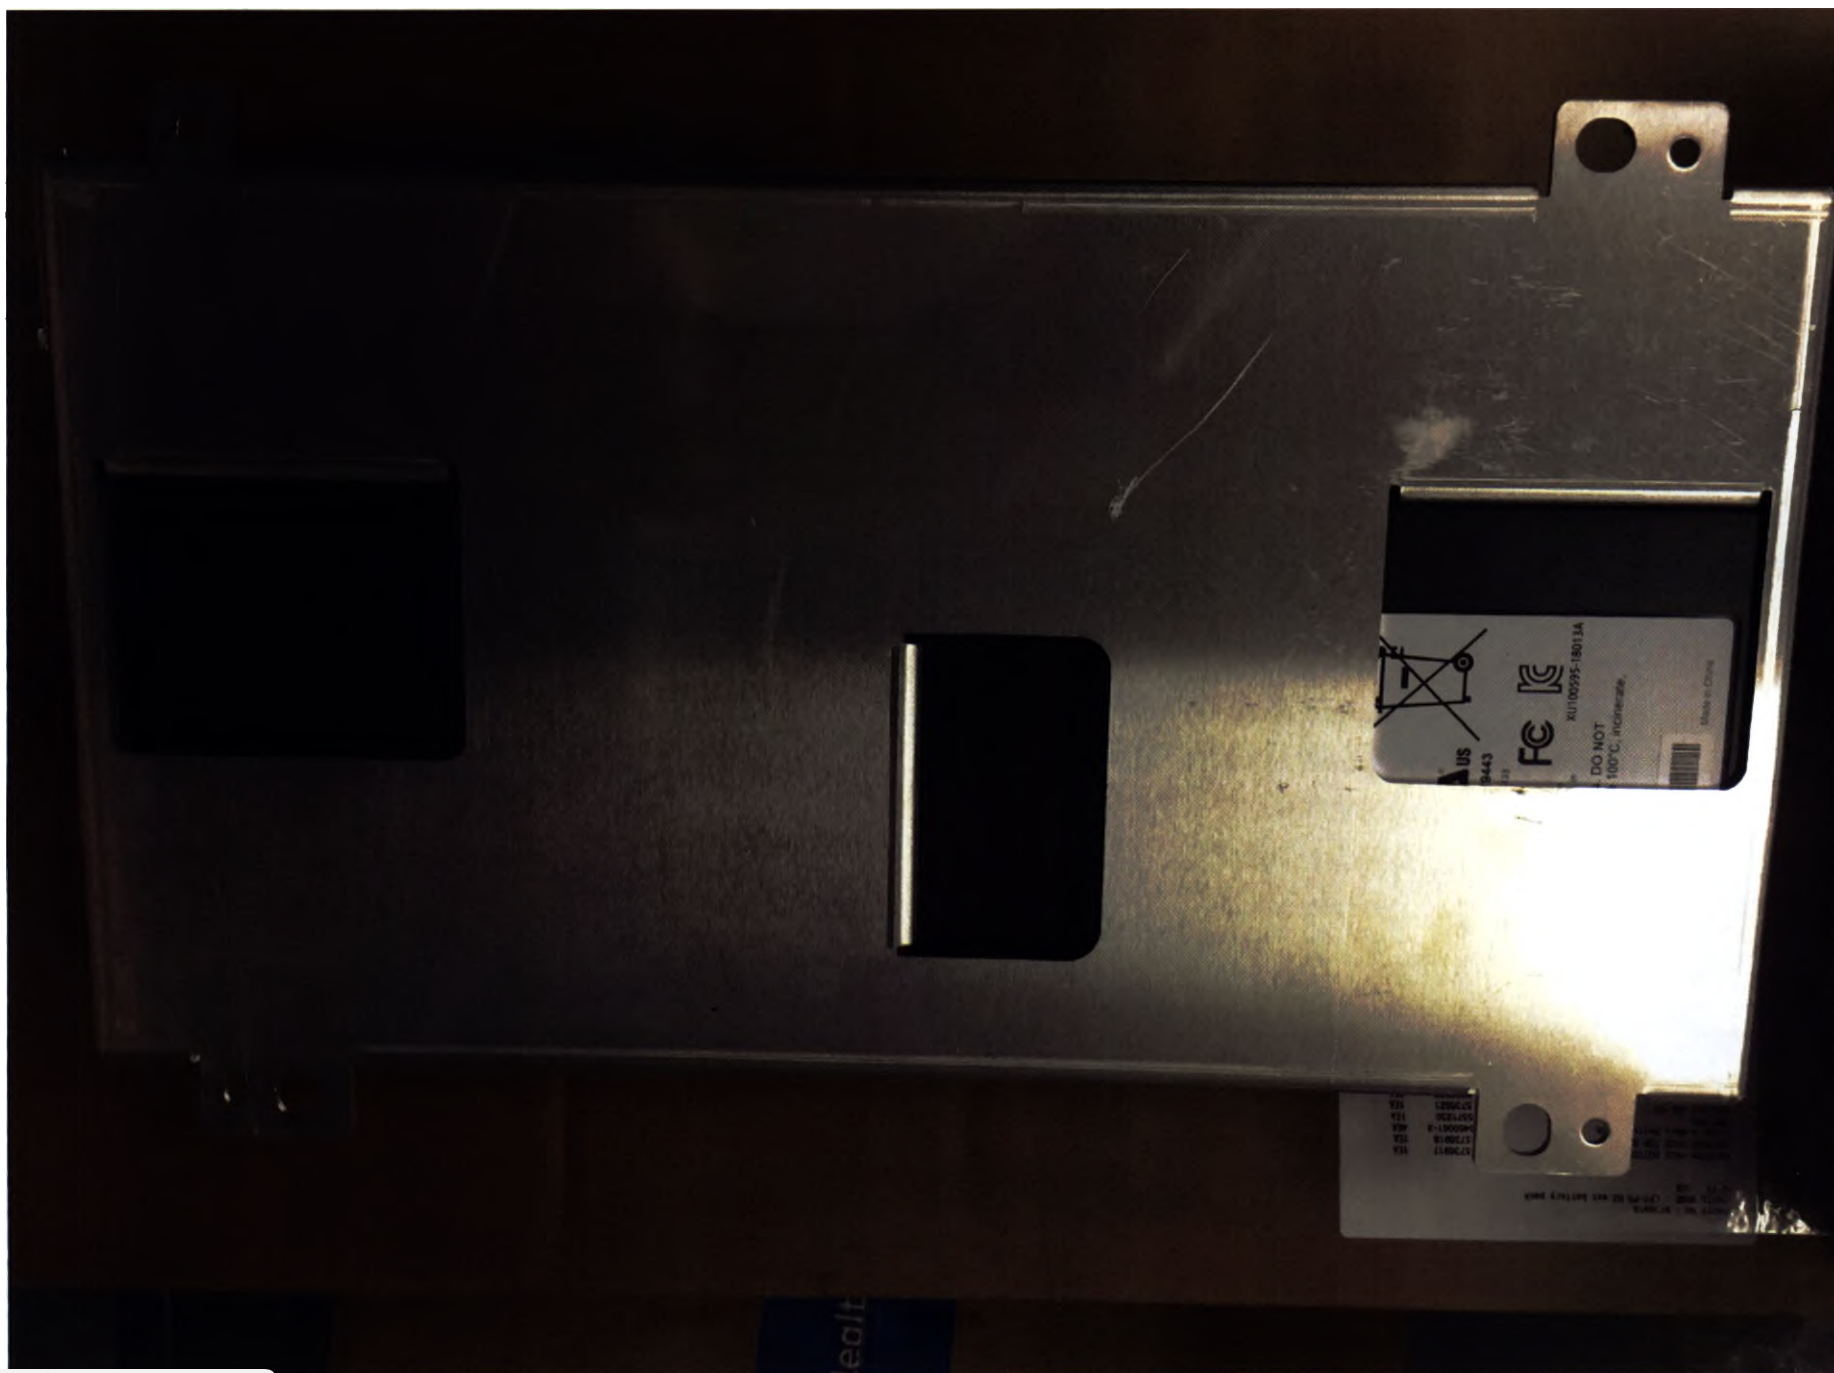


Аккумуляторные батареи (не более 5 шт.). (Версии: R4)




Аккумуляторные батареи (не более 5 шт.). (Версии: R4)

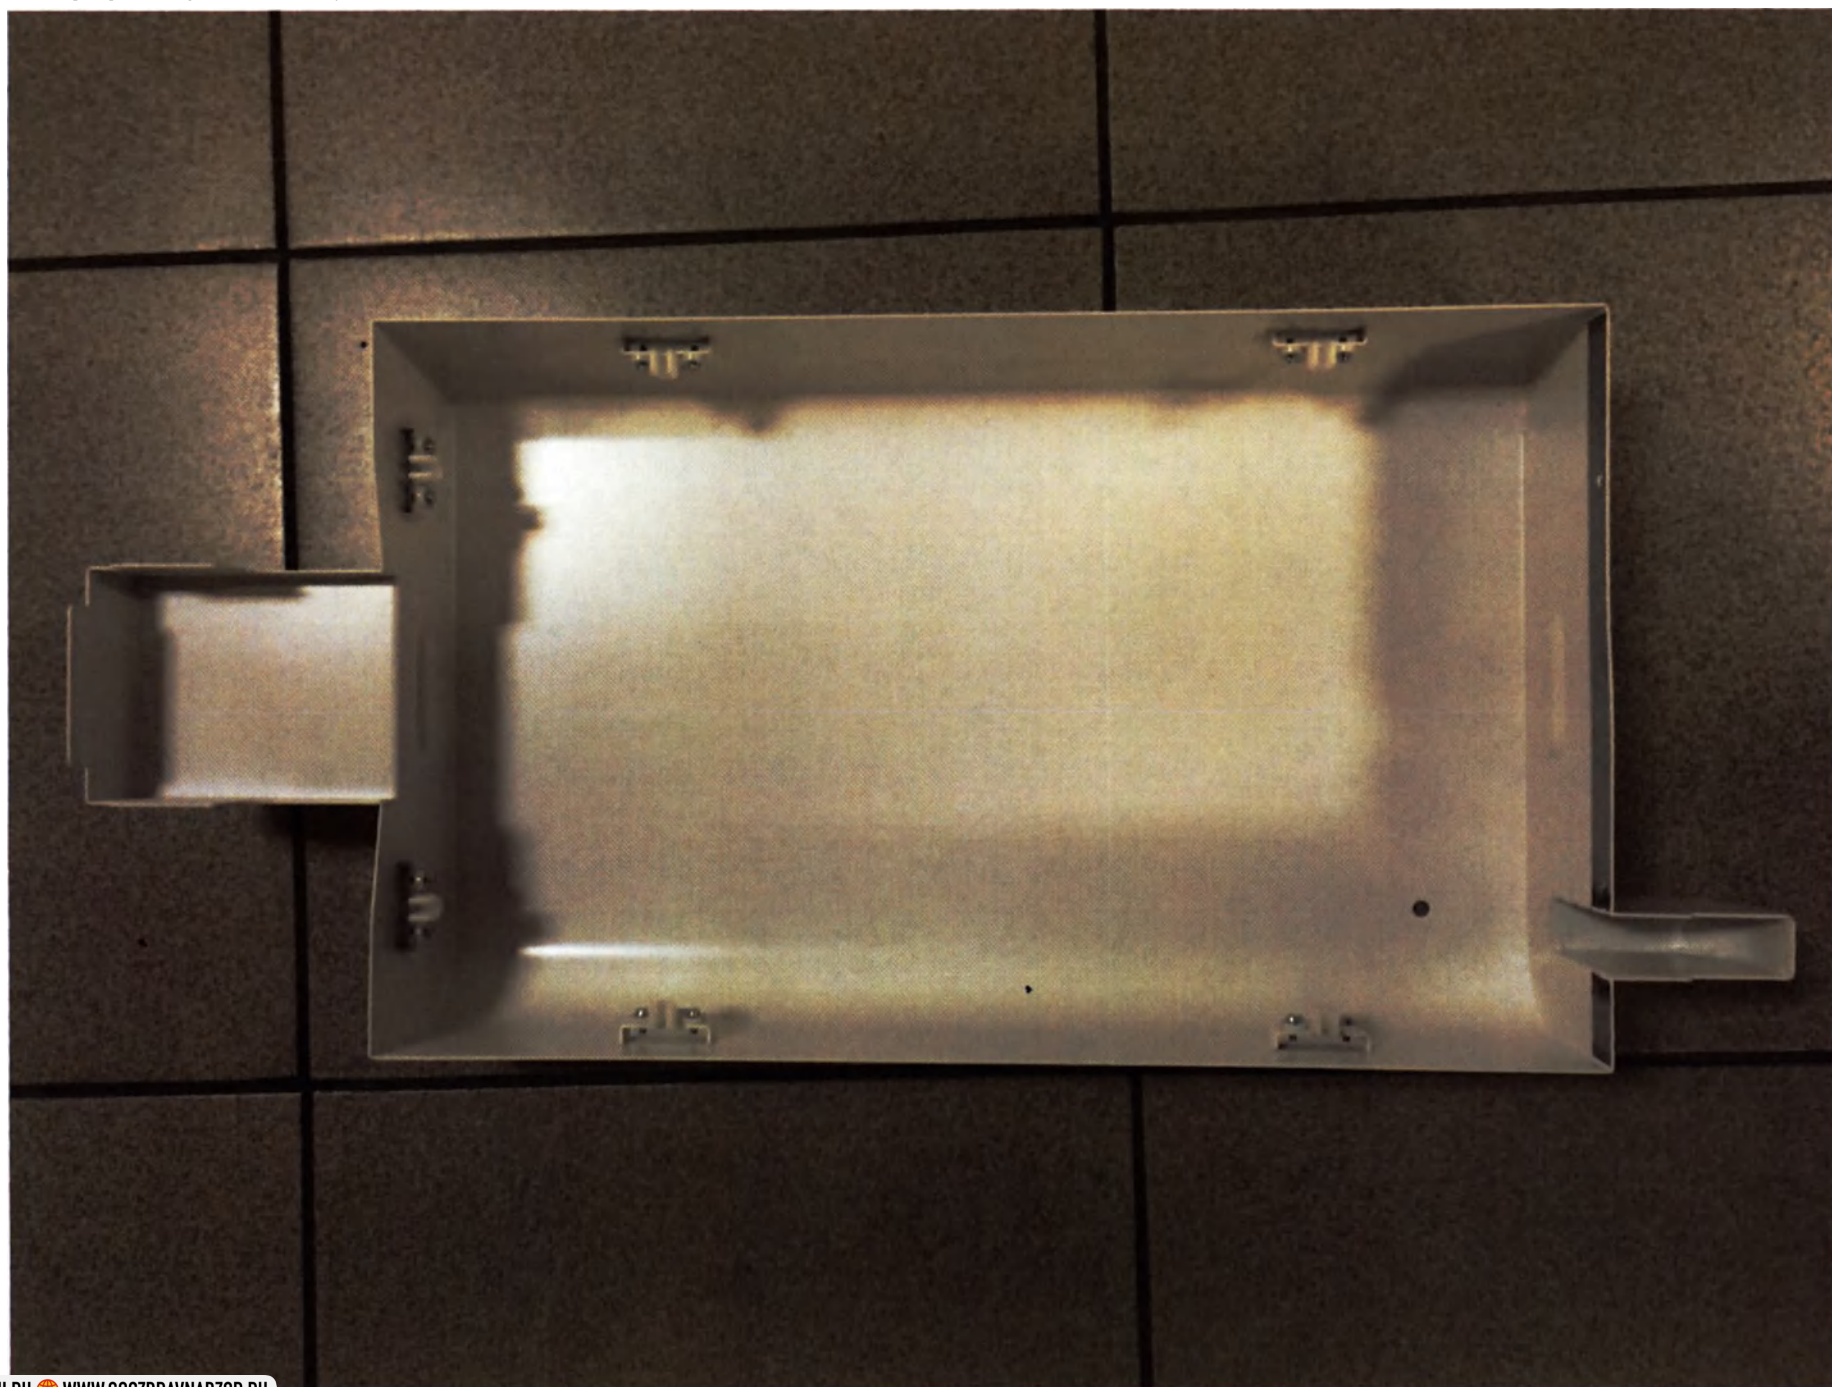

Аккумуляторные батареи (не более 5 шт.). (Версии: R4)

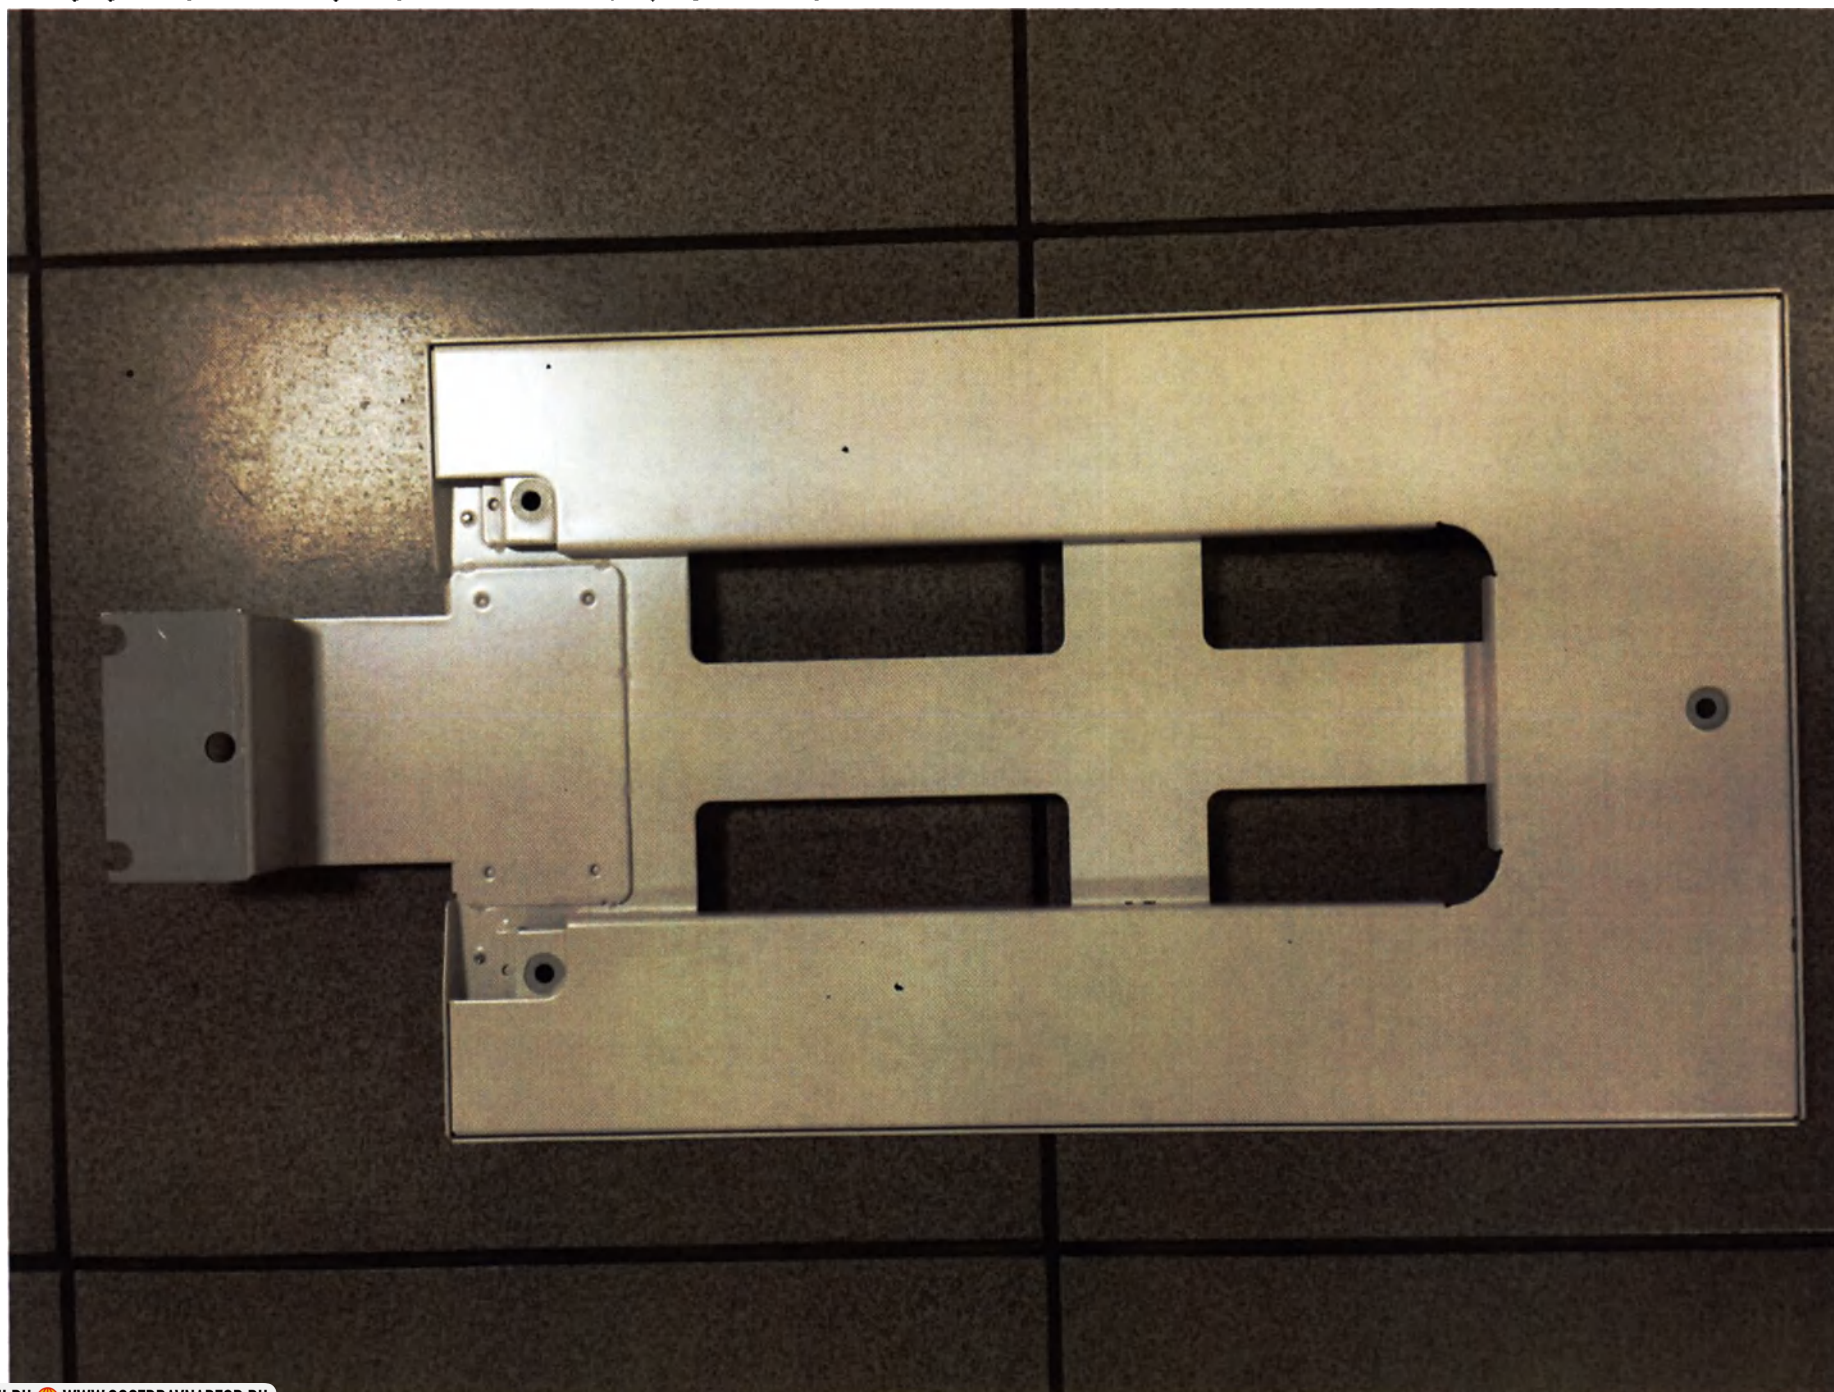


Аккумуляторные батареи (не более 5 шт.). (Версии: R4)

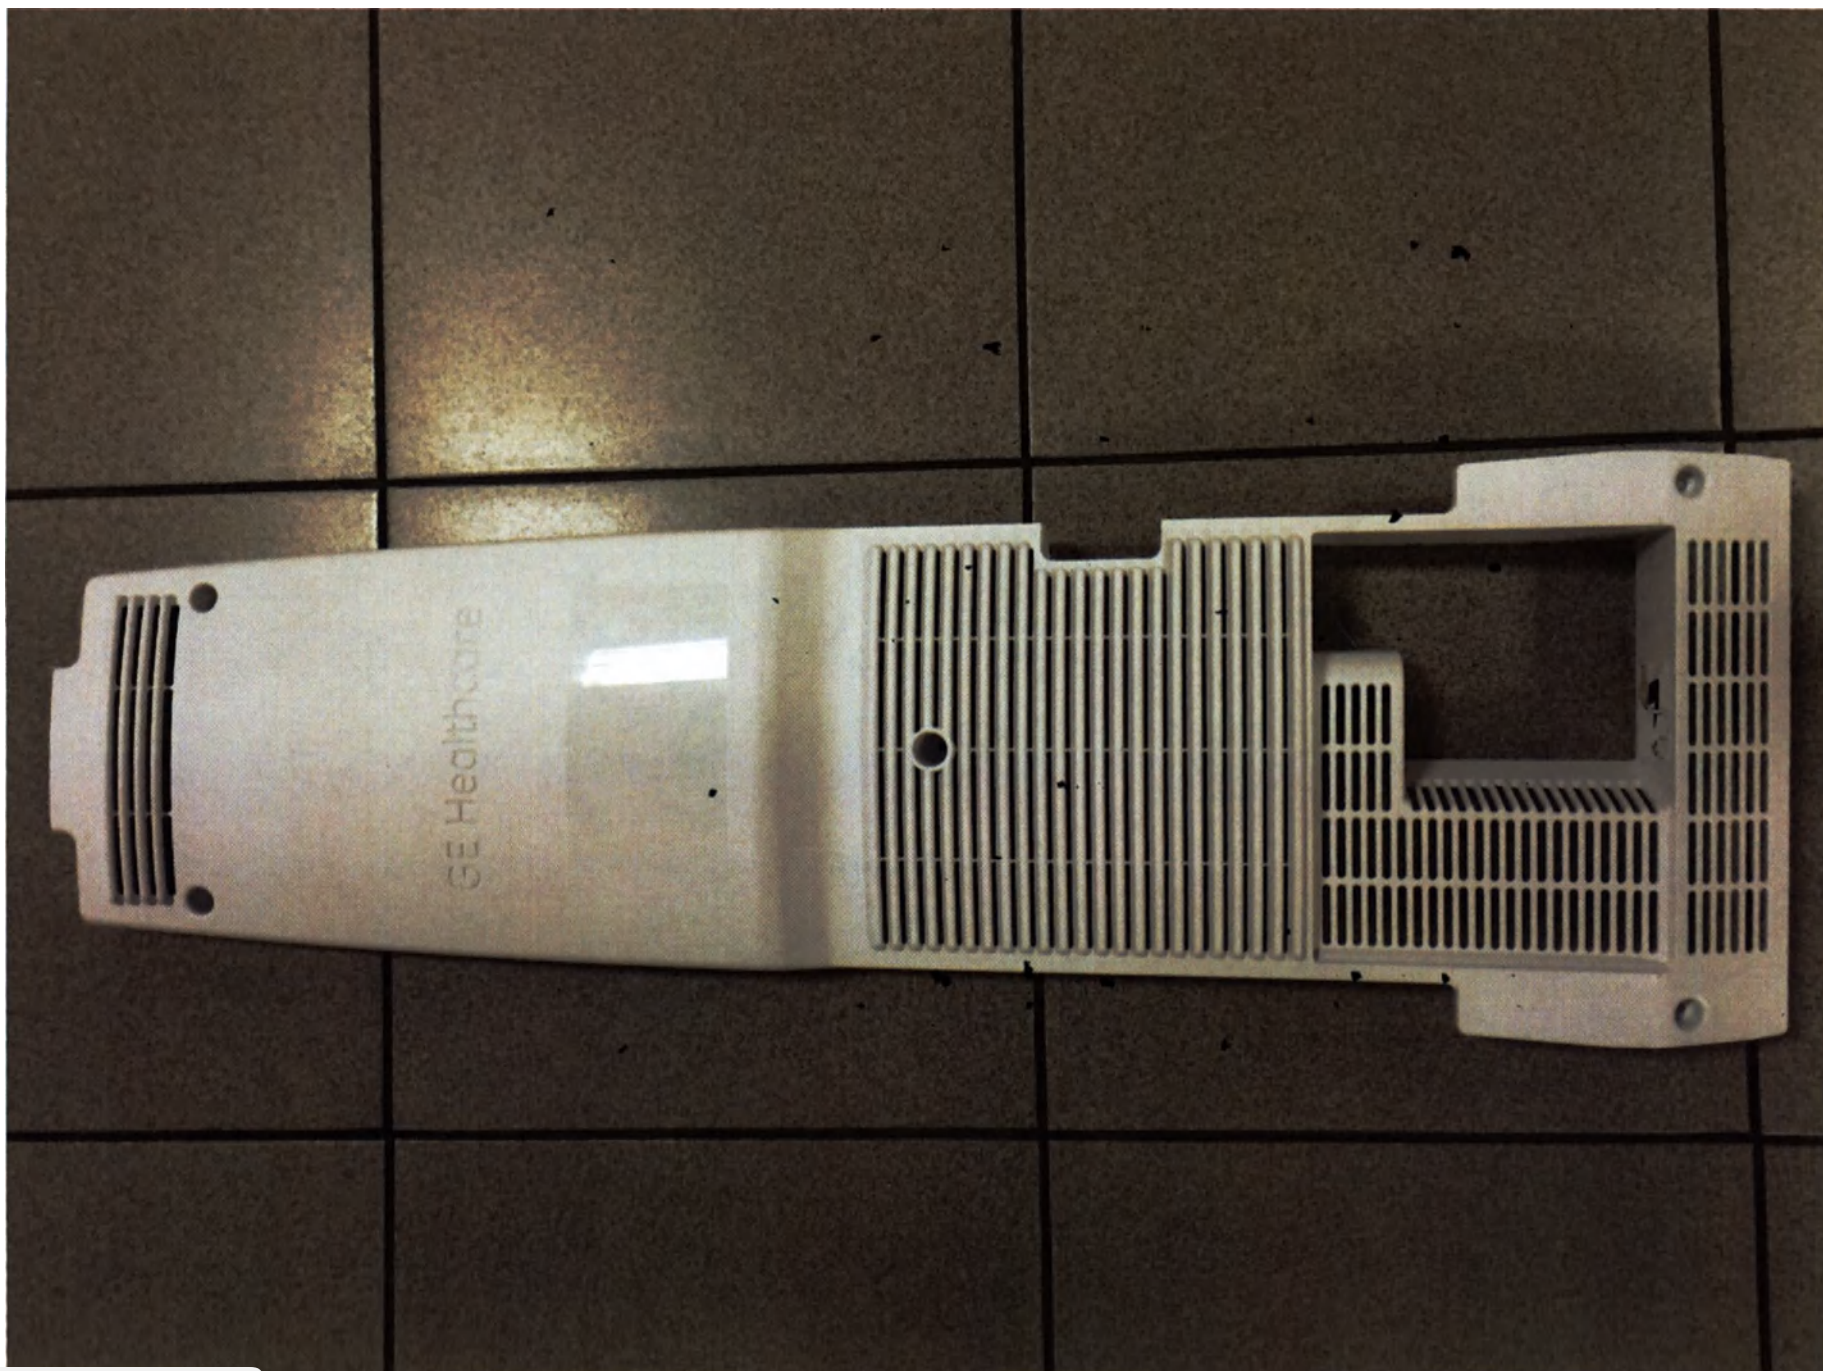


Модули для модернизации системы (не более 3 шт.). (Версии: R2, R3, R4)




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме эластографии сдвиговой волны Shear Wave Elastography. (Версии: R3, R4)

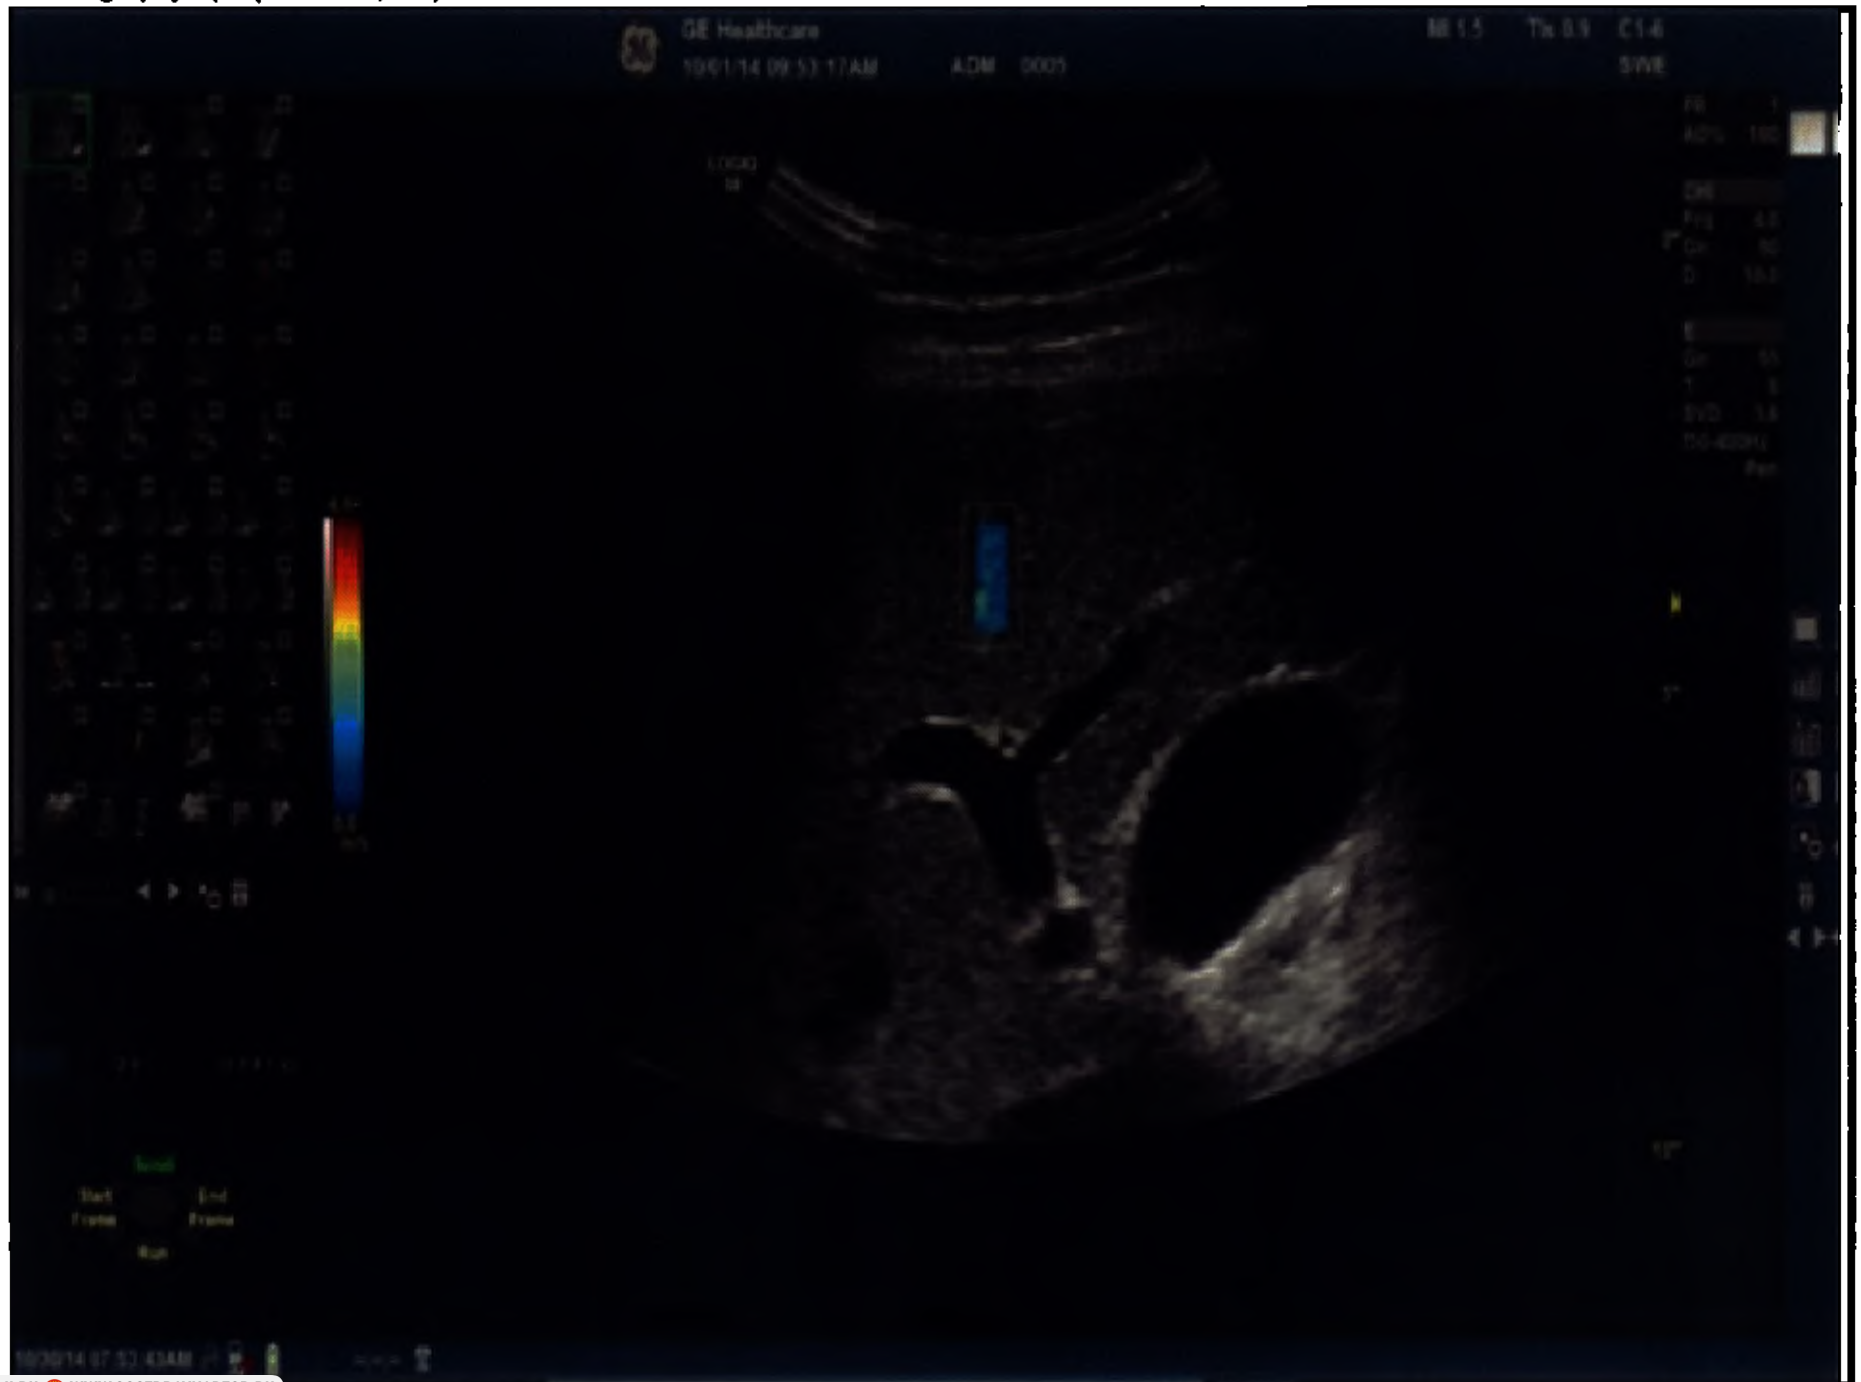



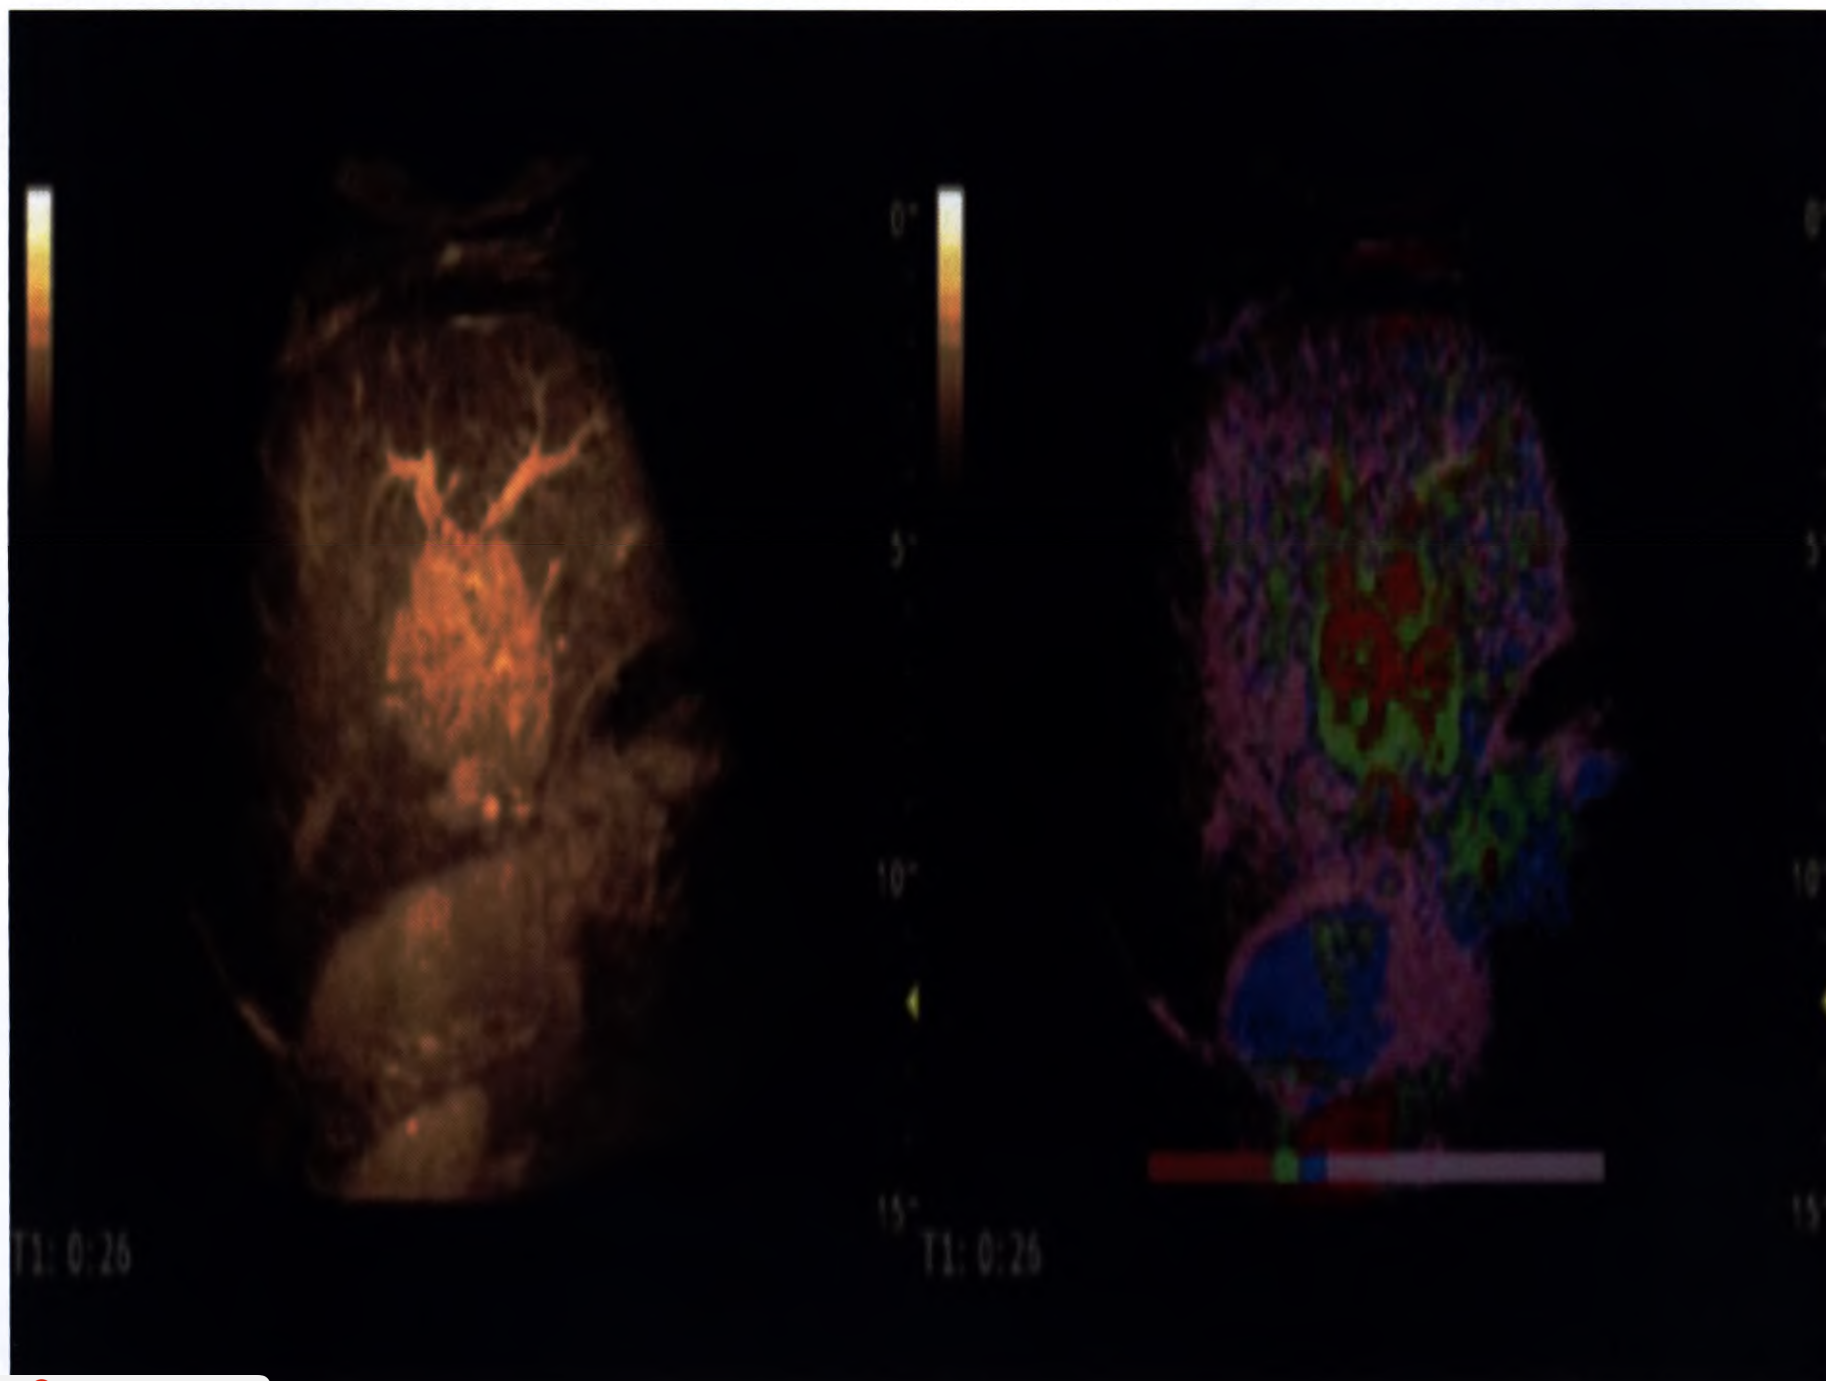


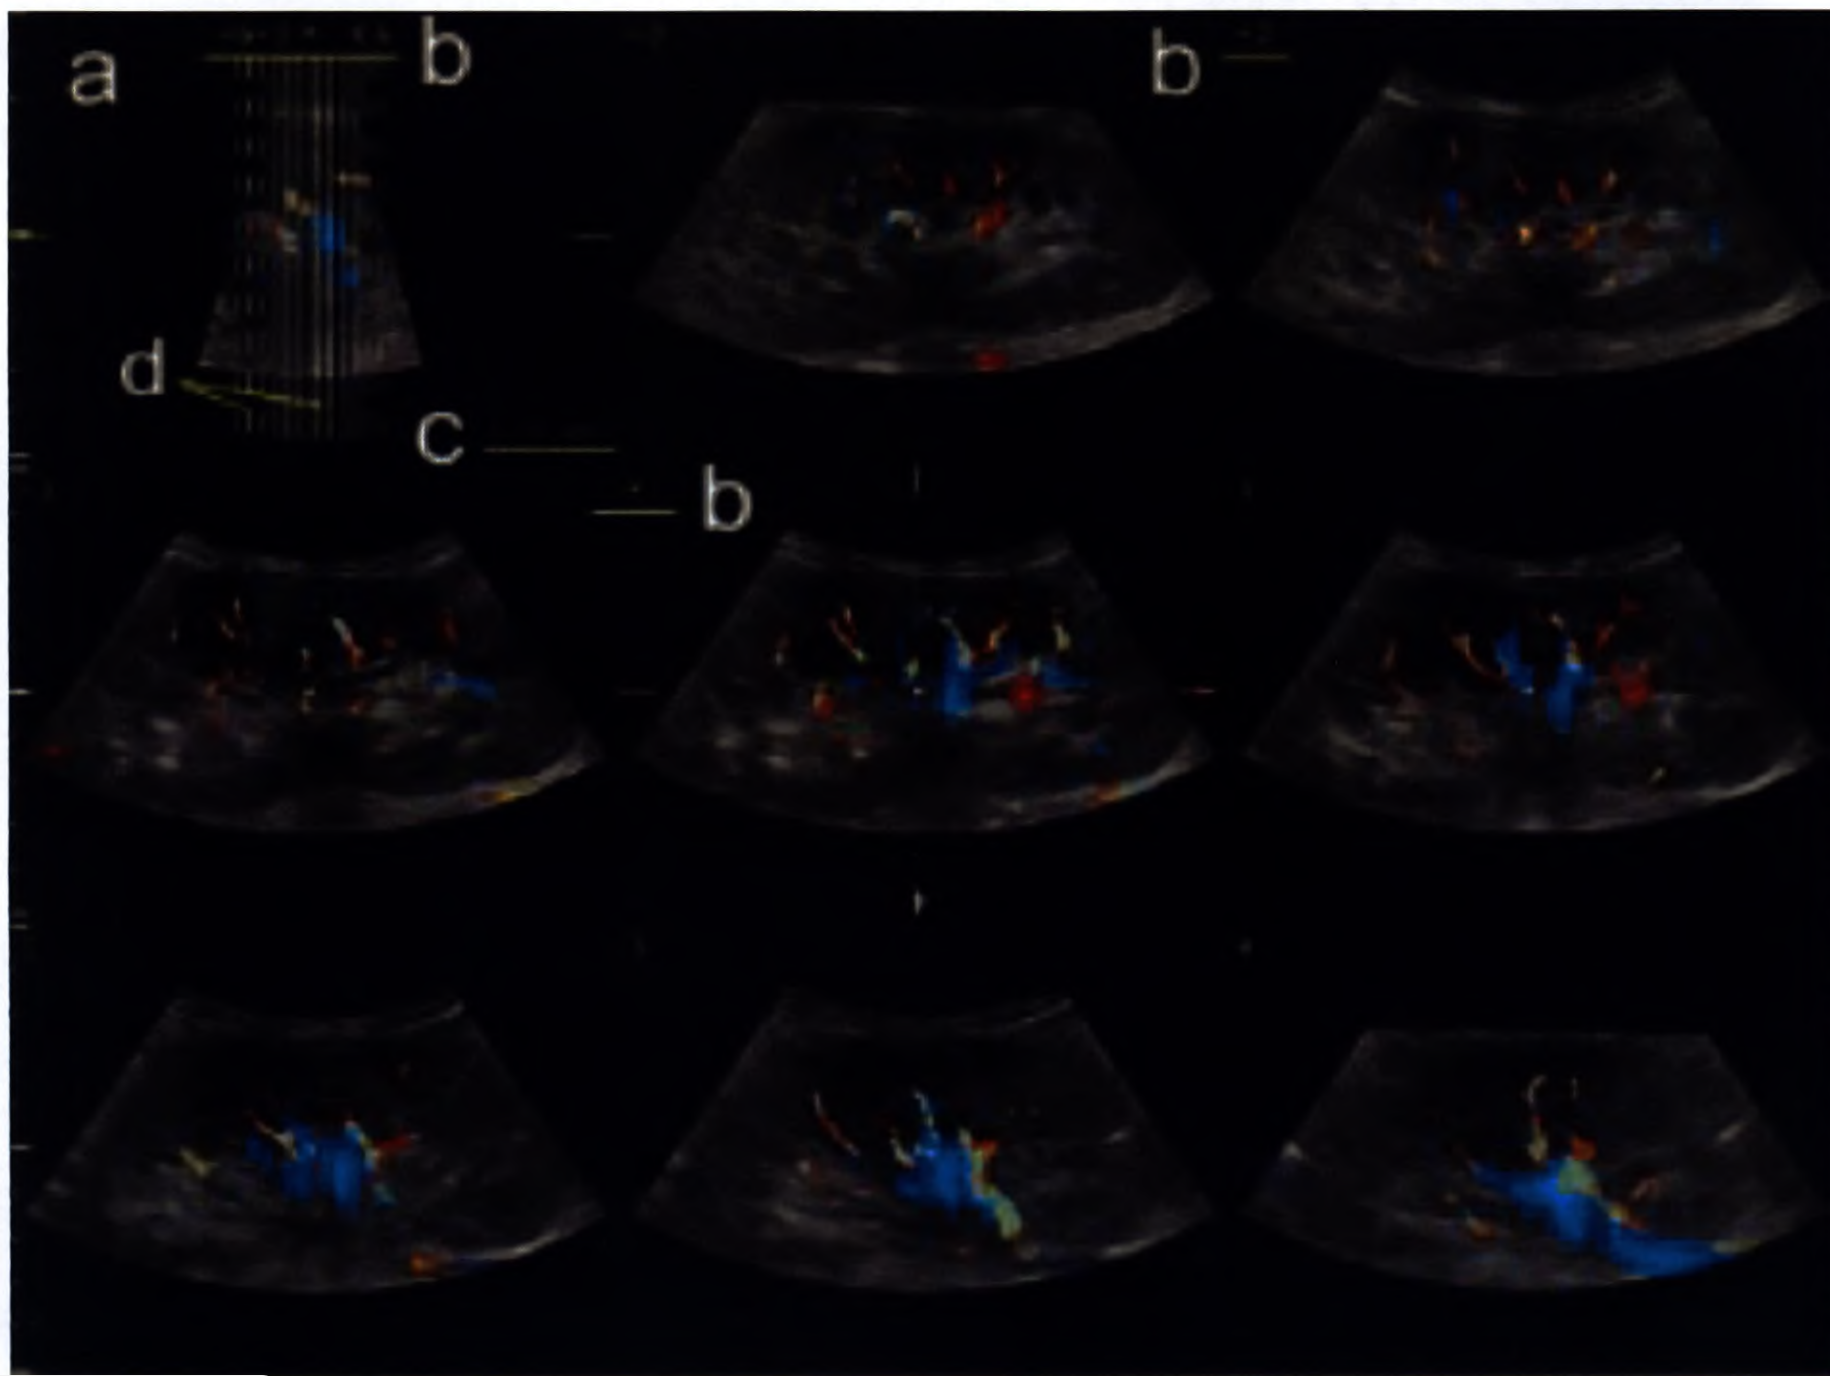


Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Auto EF. (Версии: R2, R3, R4)






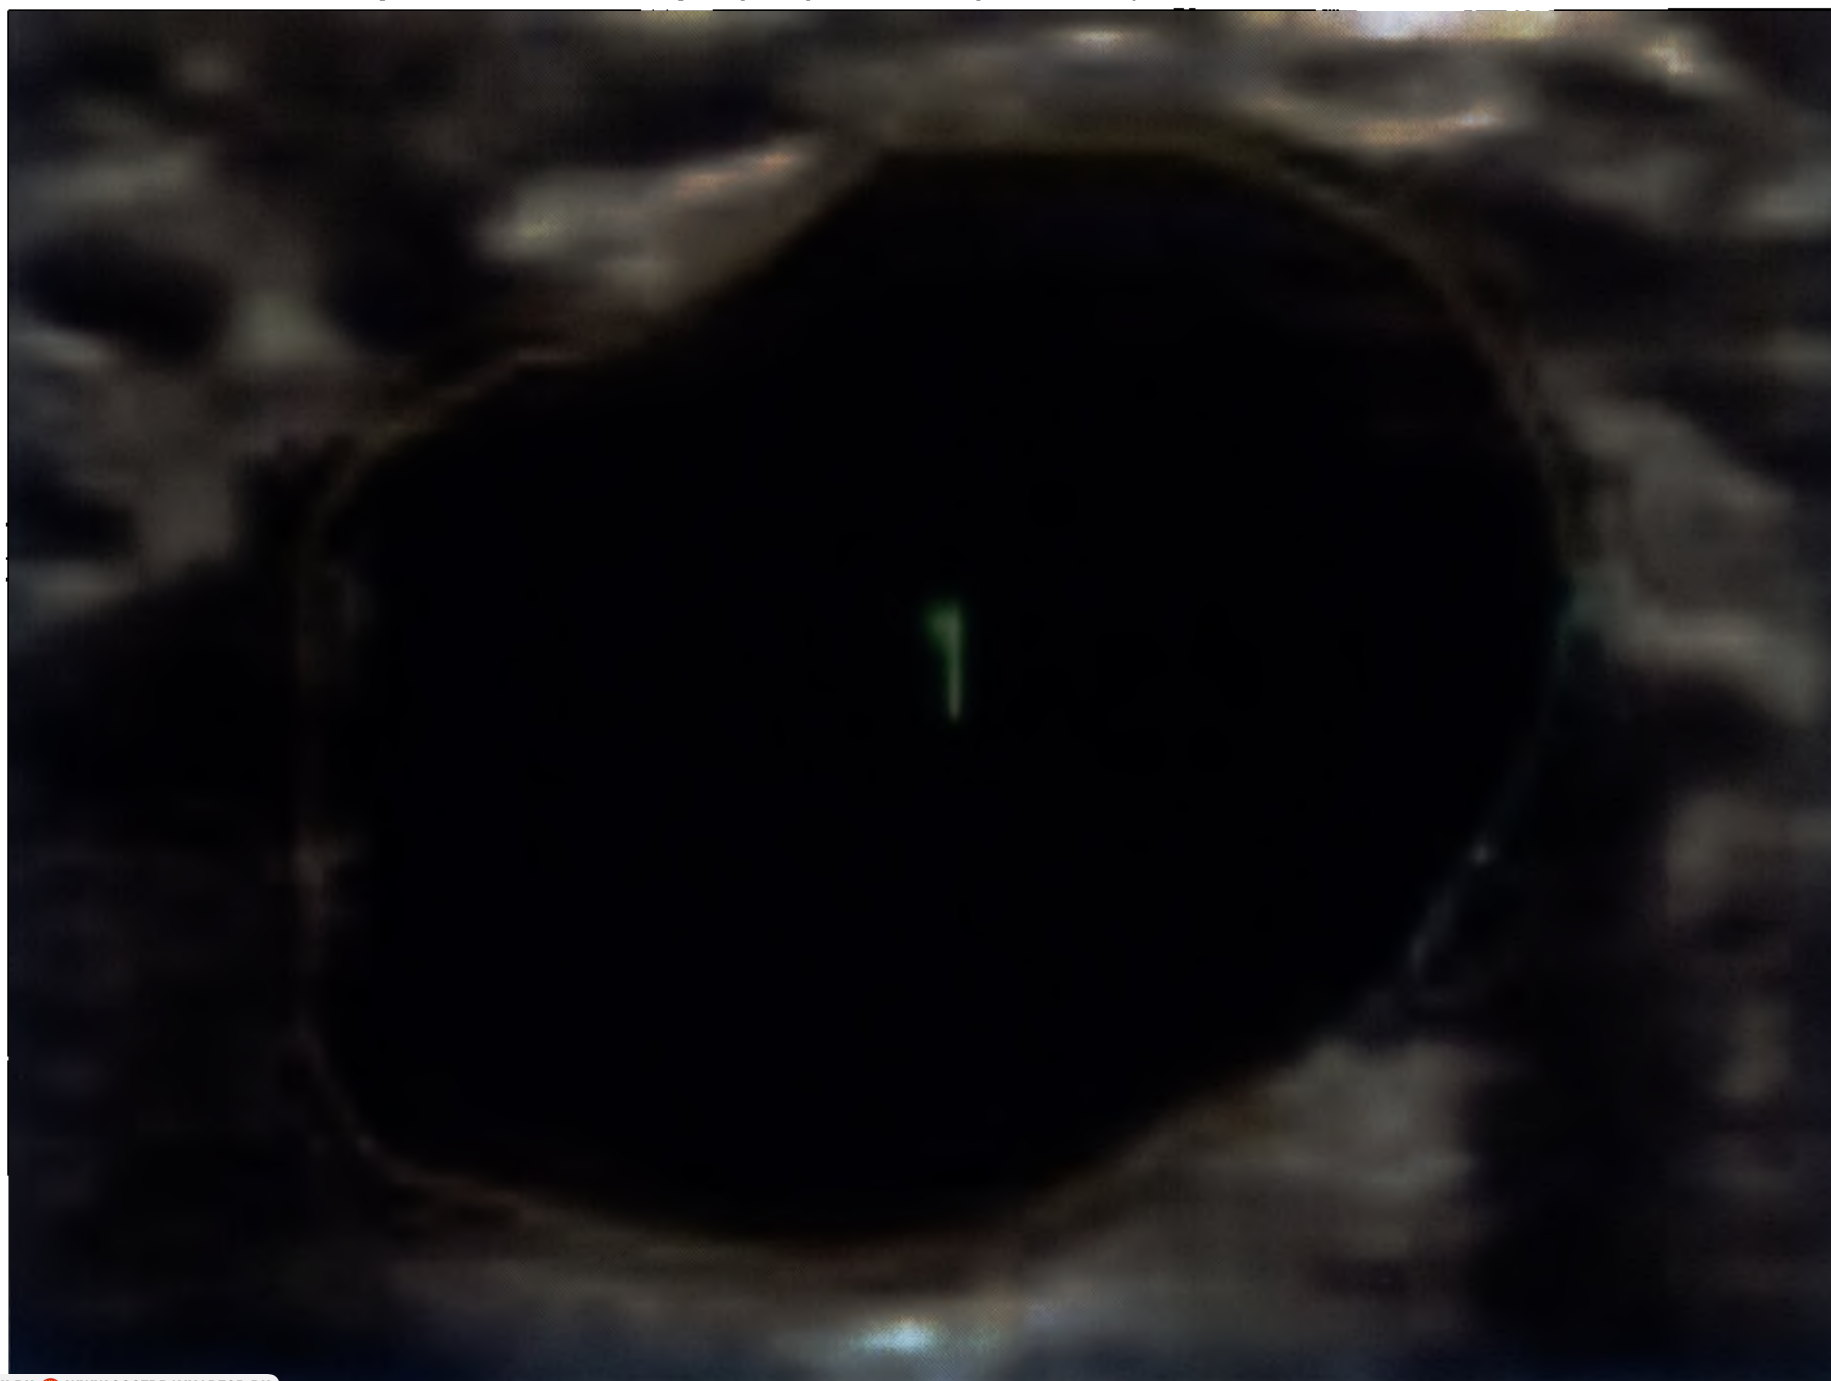

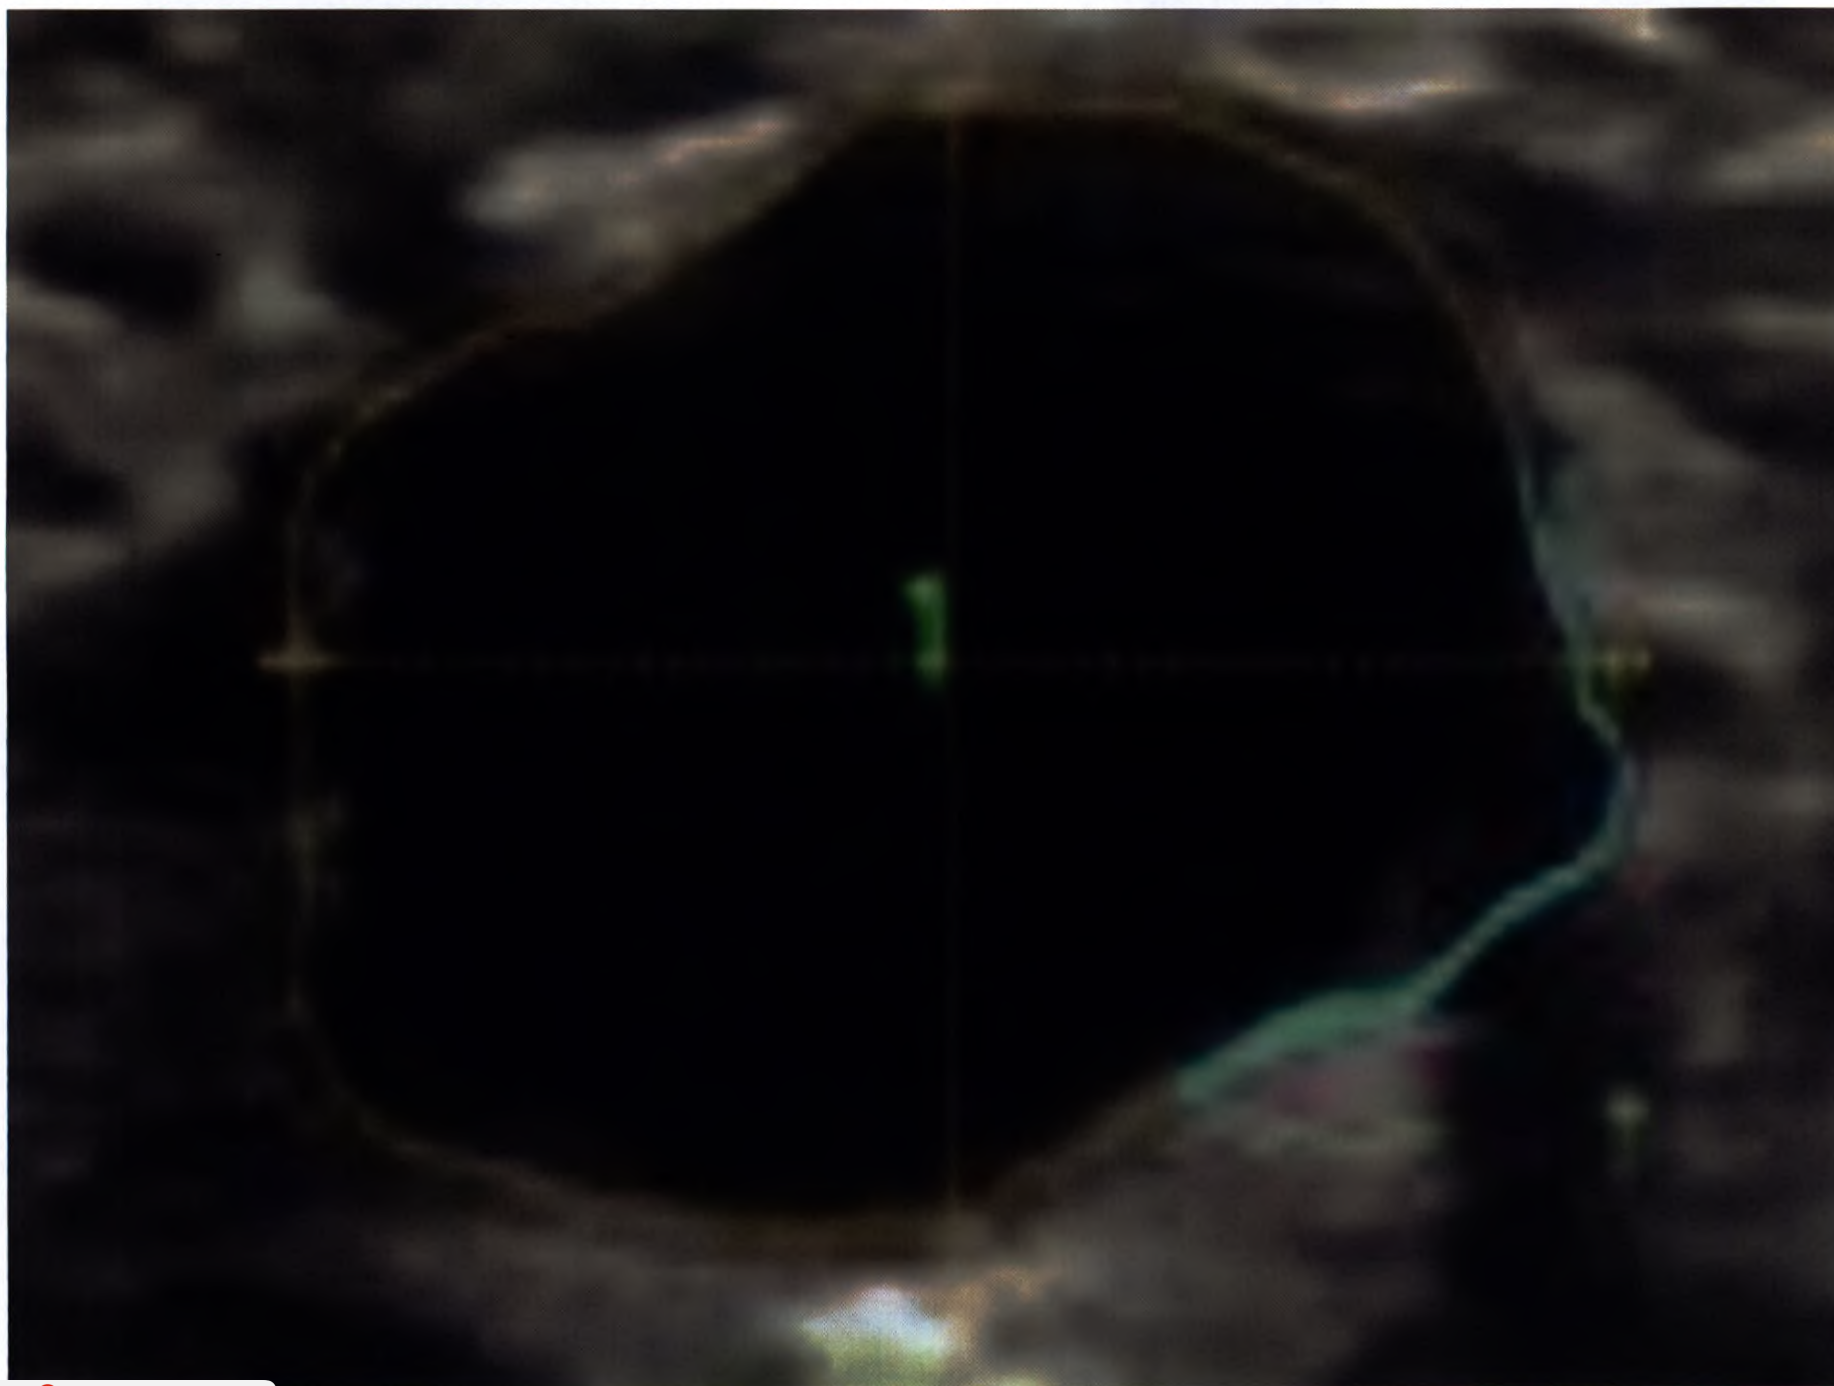










CON	
Frq	Gen
Gn	45
S/A	0/4
Map	K/0
D	13.0
DR	57
AO%	-
Trig	0-1
Vis	C
Tch	HR




Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской со встроенным системным блоком (производство АО «МТЛ»)
(Версии: R4)

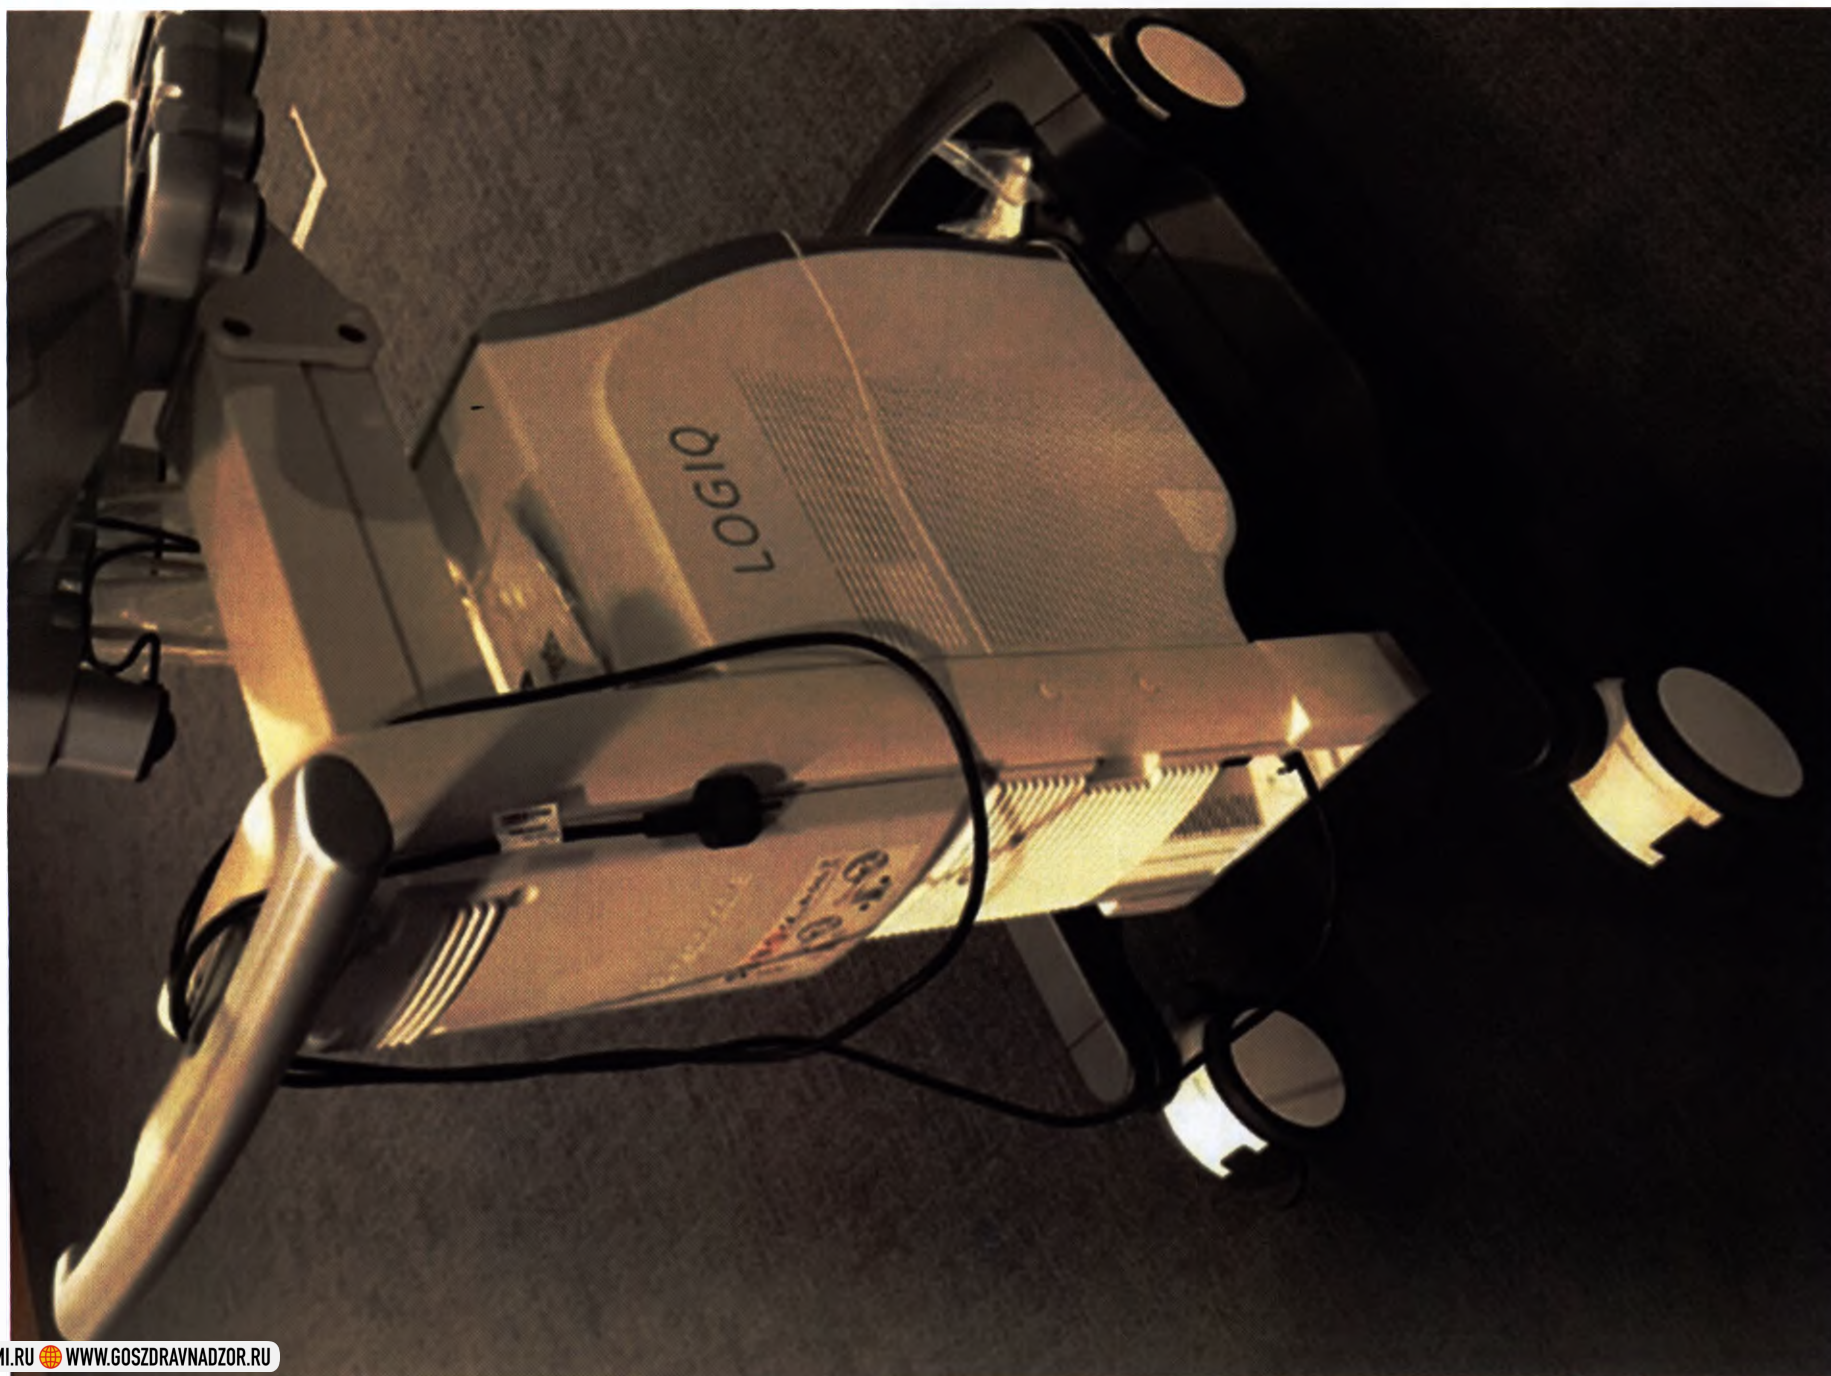

Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской со встроенным системным блоком (производство АО «МТЛ»)
(Версии: R3)



Кожухи для системного блока (производство АО «МТЛ») (Версии: R4)

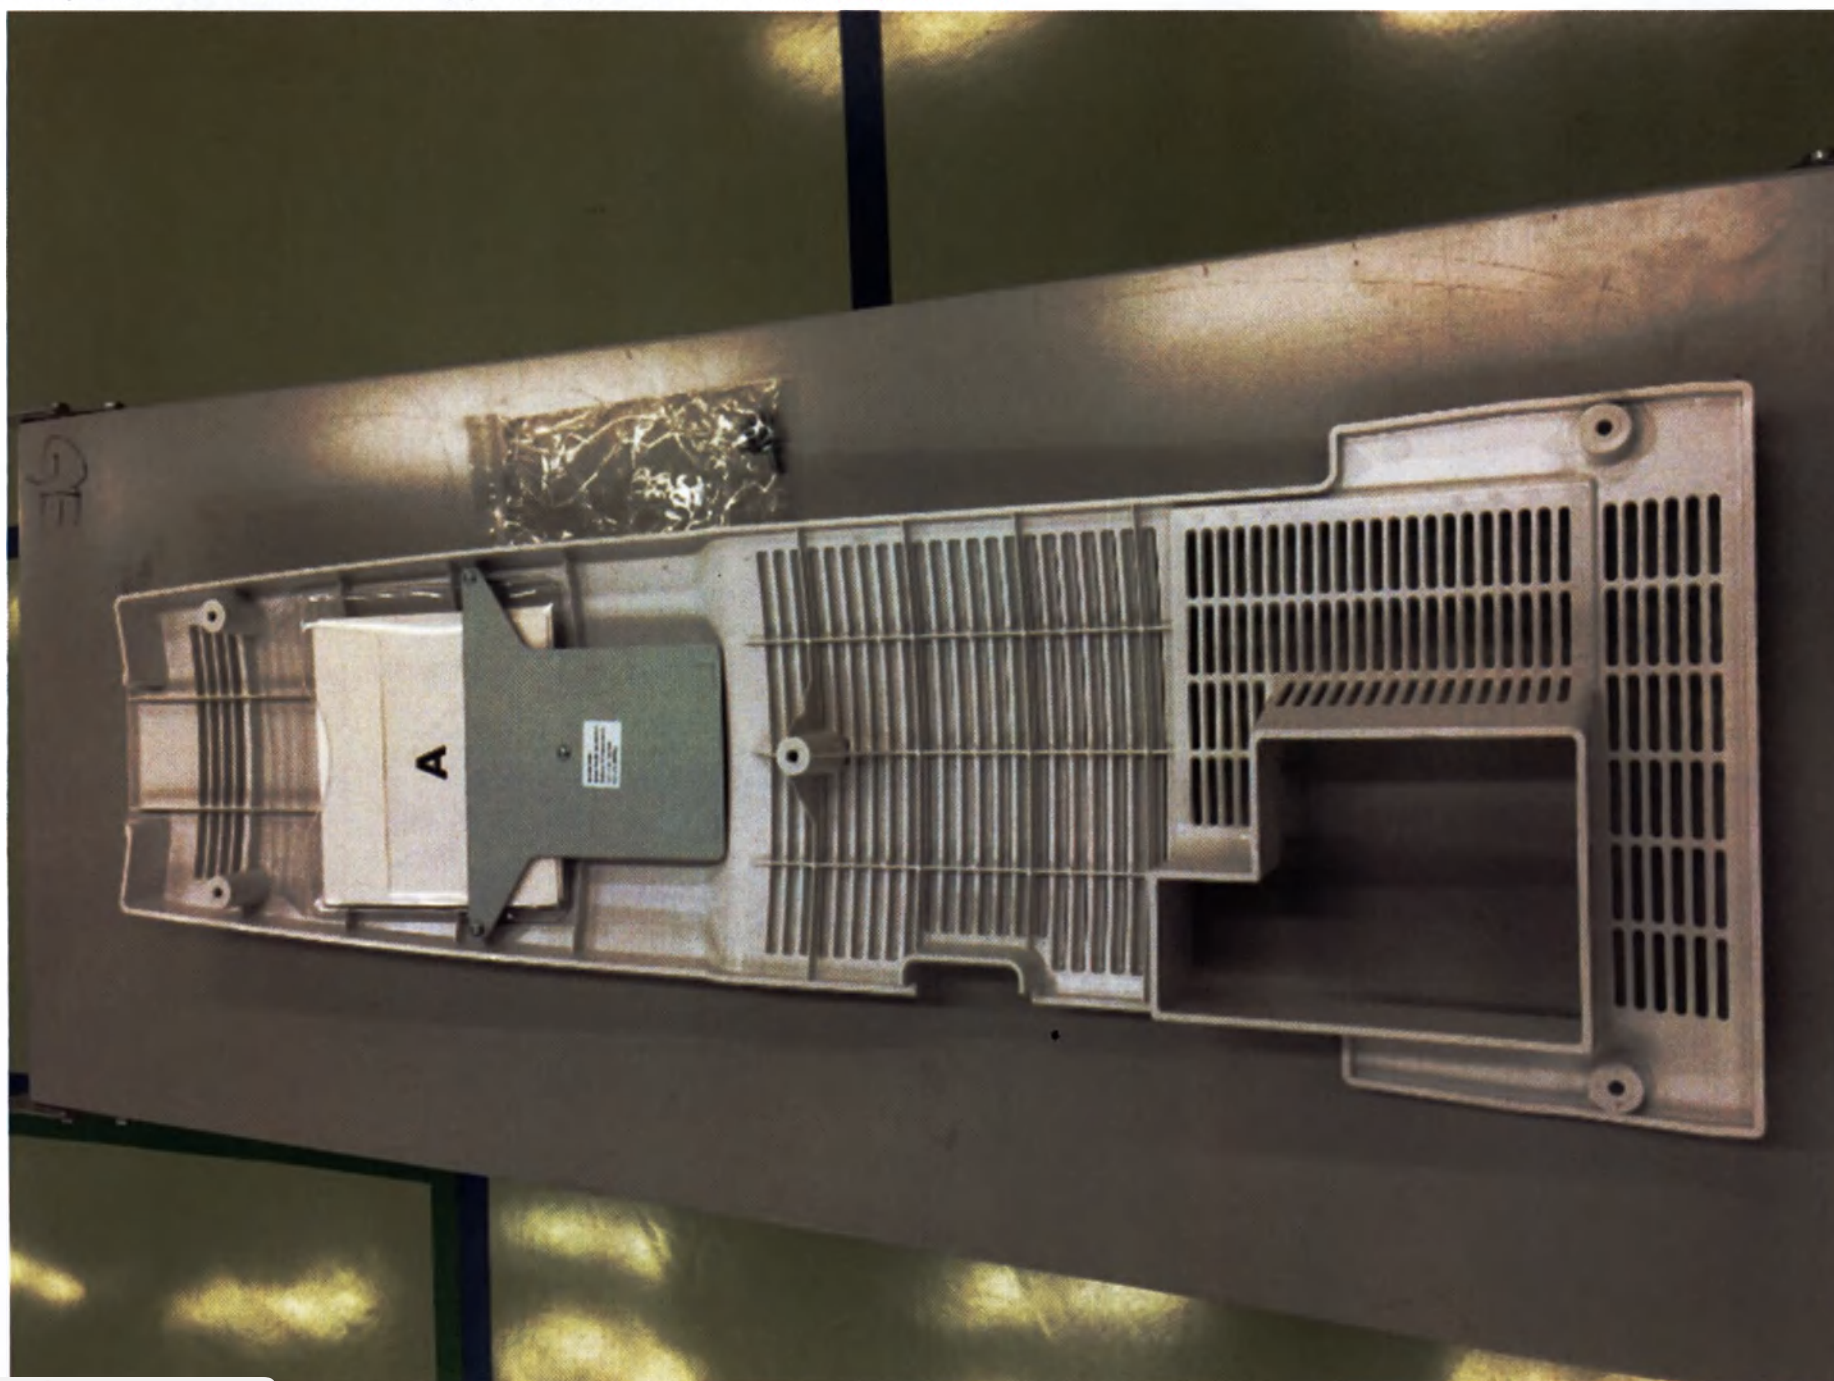

Кожухи для системного блока (производство АО «МТЛ») (Версии: R3)




Панель управления с кнопками и сенсорным экраном (производство АО «МТЛ») (Версии: R4)



Панель управления с кнопками и сенсорным экраном (производство АО «МТЛ») (Версии: R3)



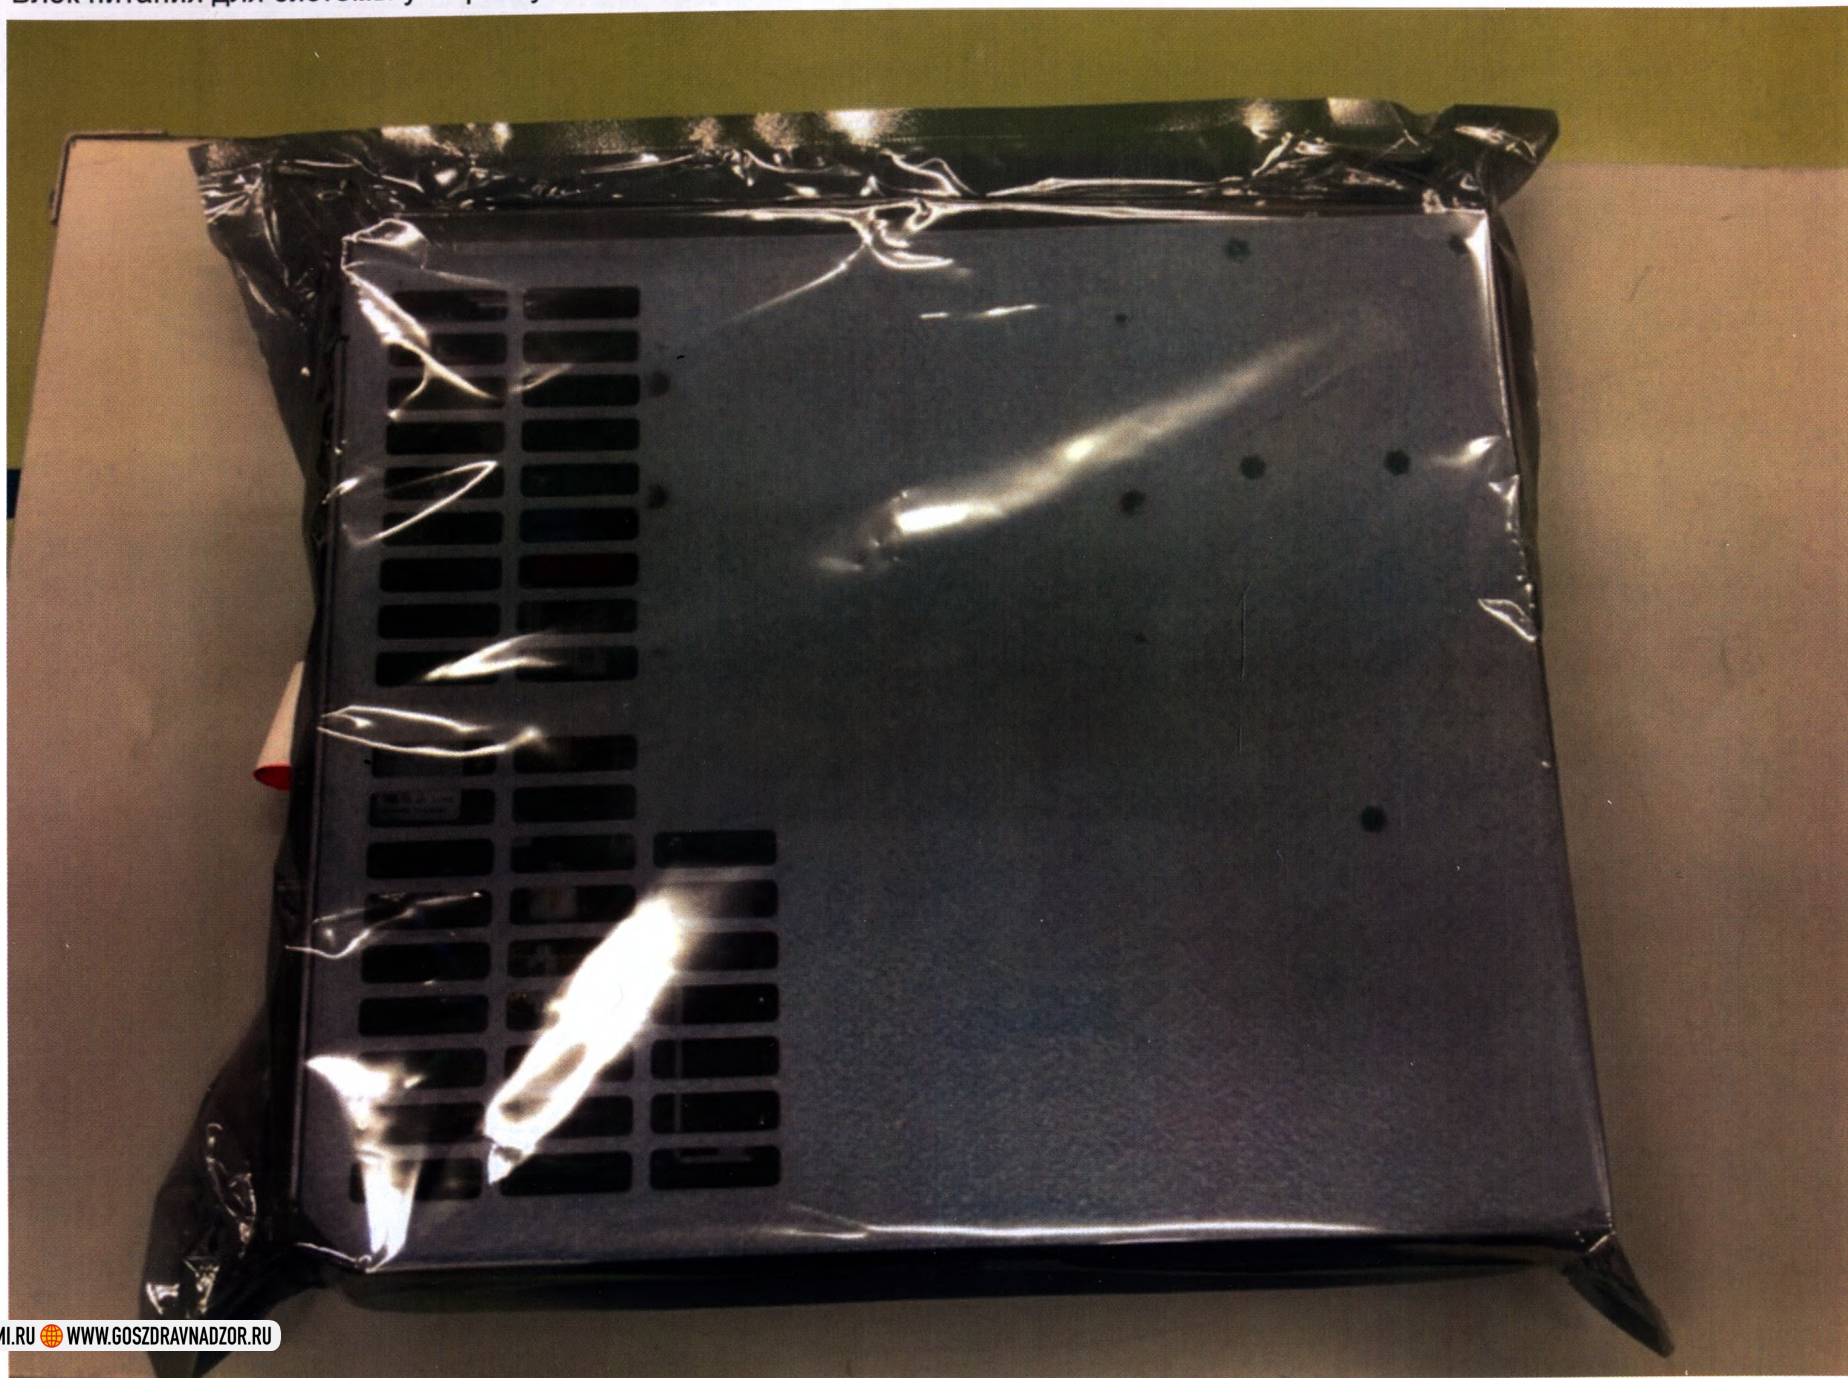



Шлях -
ПРОШТО
Лист в 249

