

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»



Перцева Н. Н.


«06» сентября 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного
сердечного тропонина Т в сыворотке и плазме крови человека (HS-cTnT CLIA
Microparticles (HS-cTnT)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии
AutoLumo




Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов

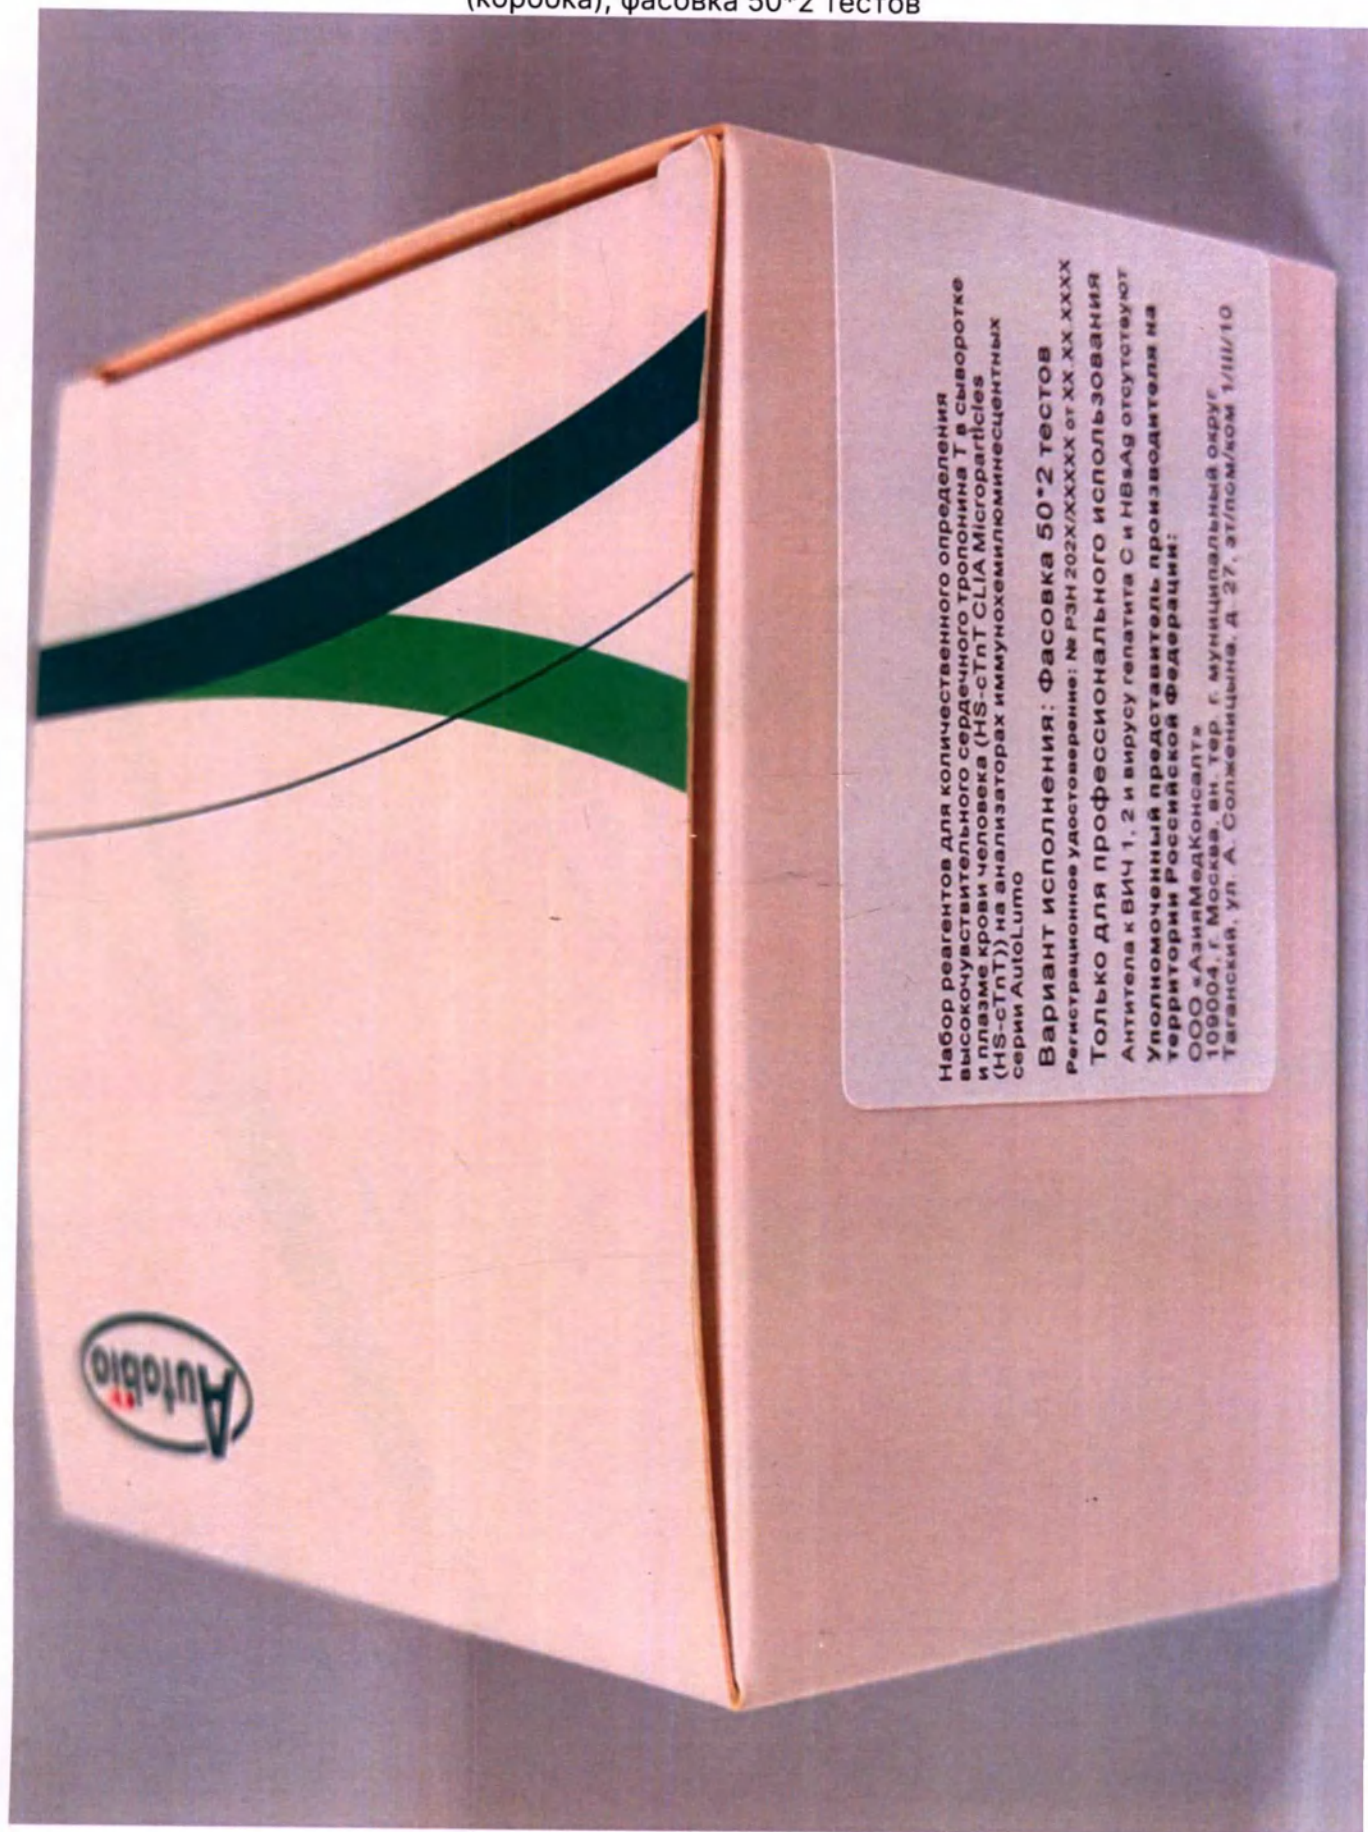



Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов



Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов (Вариант картриджа № 1)

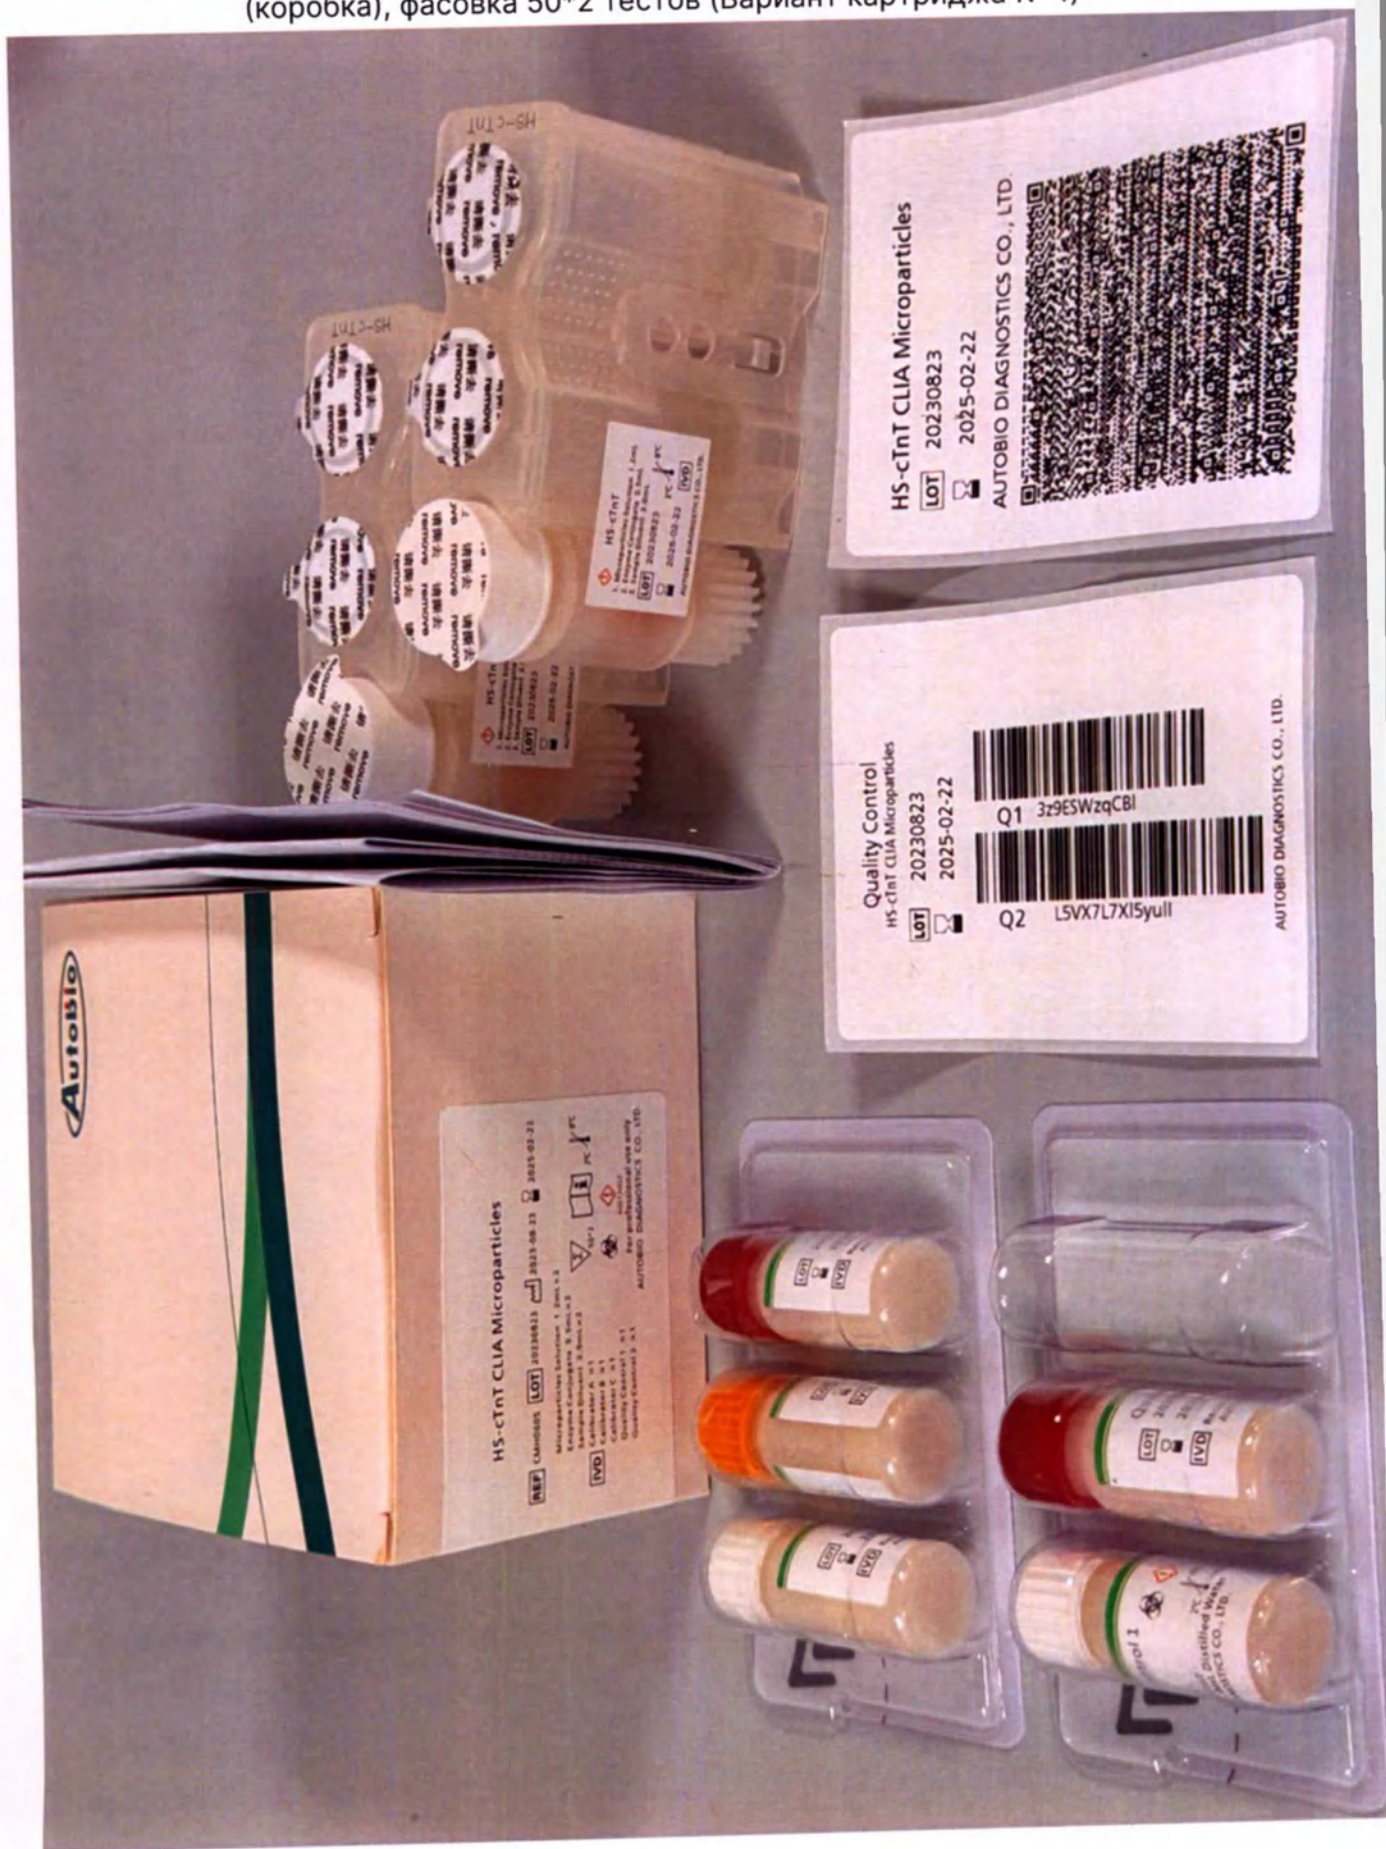

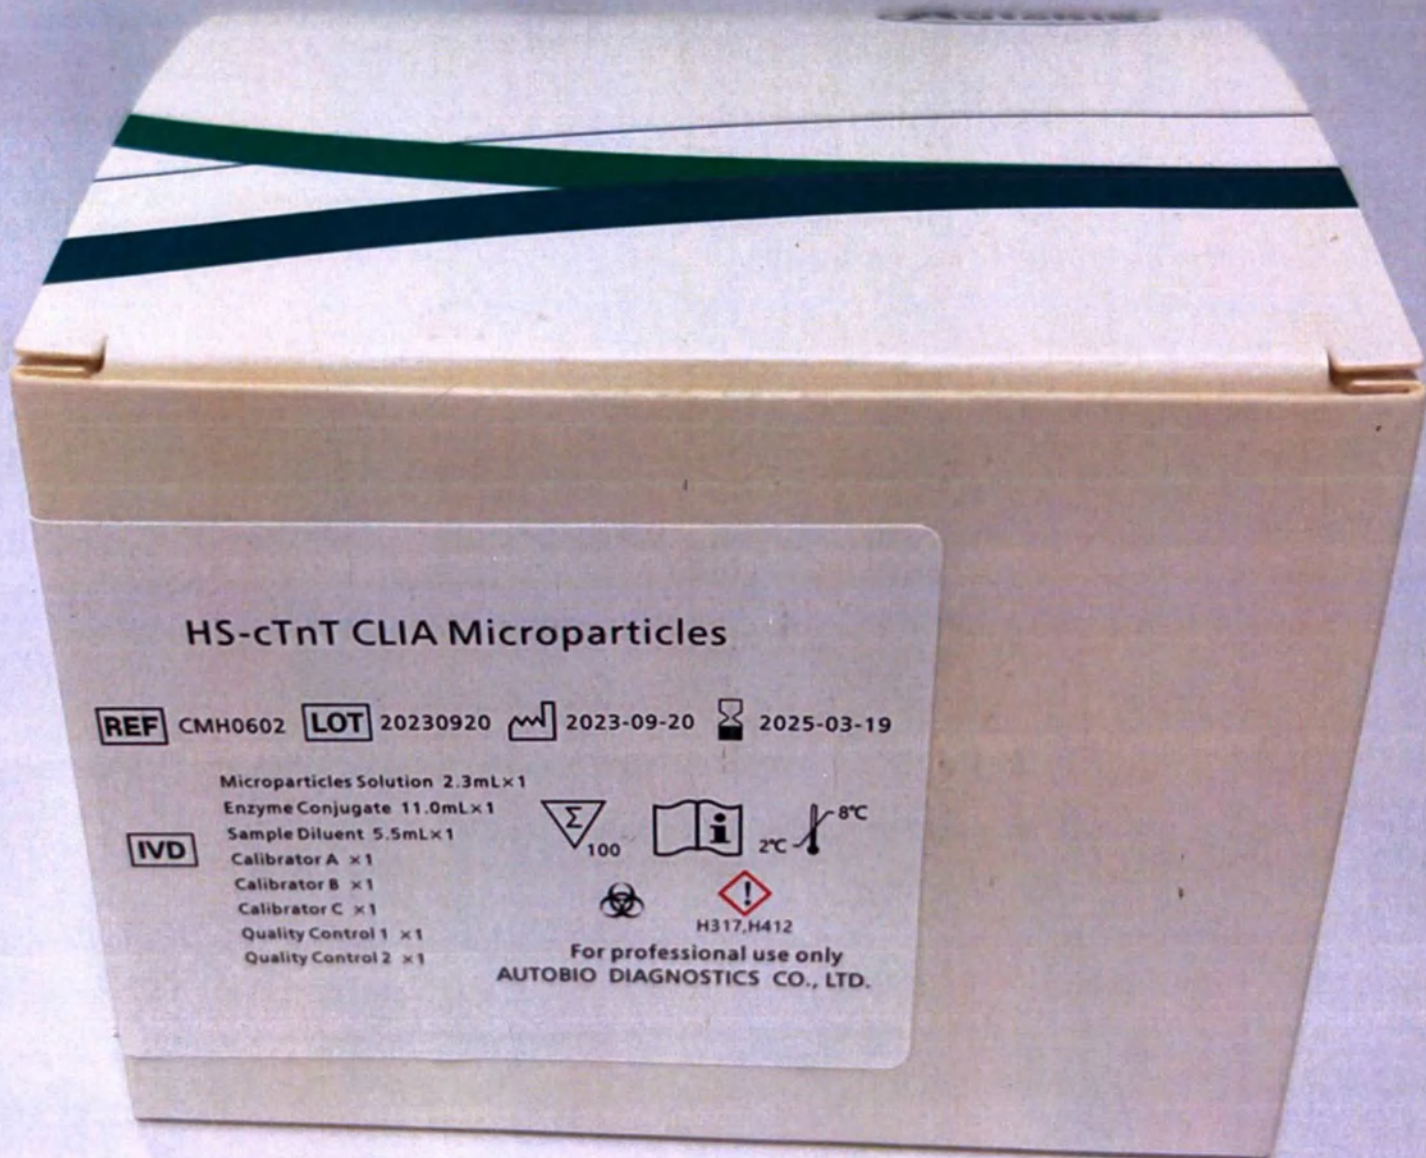


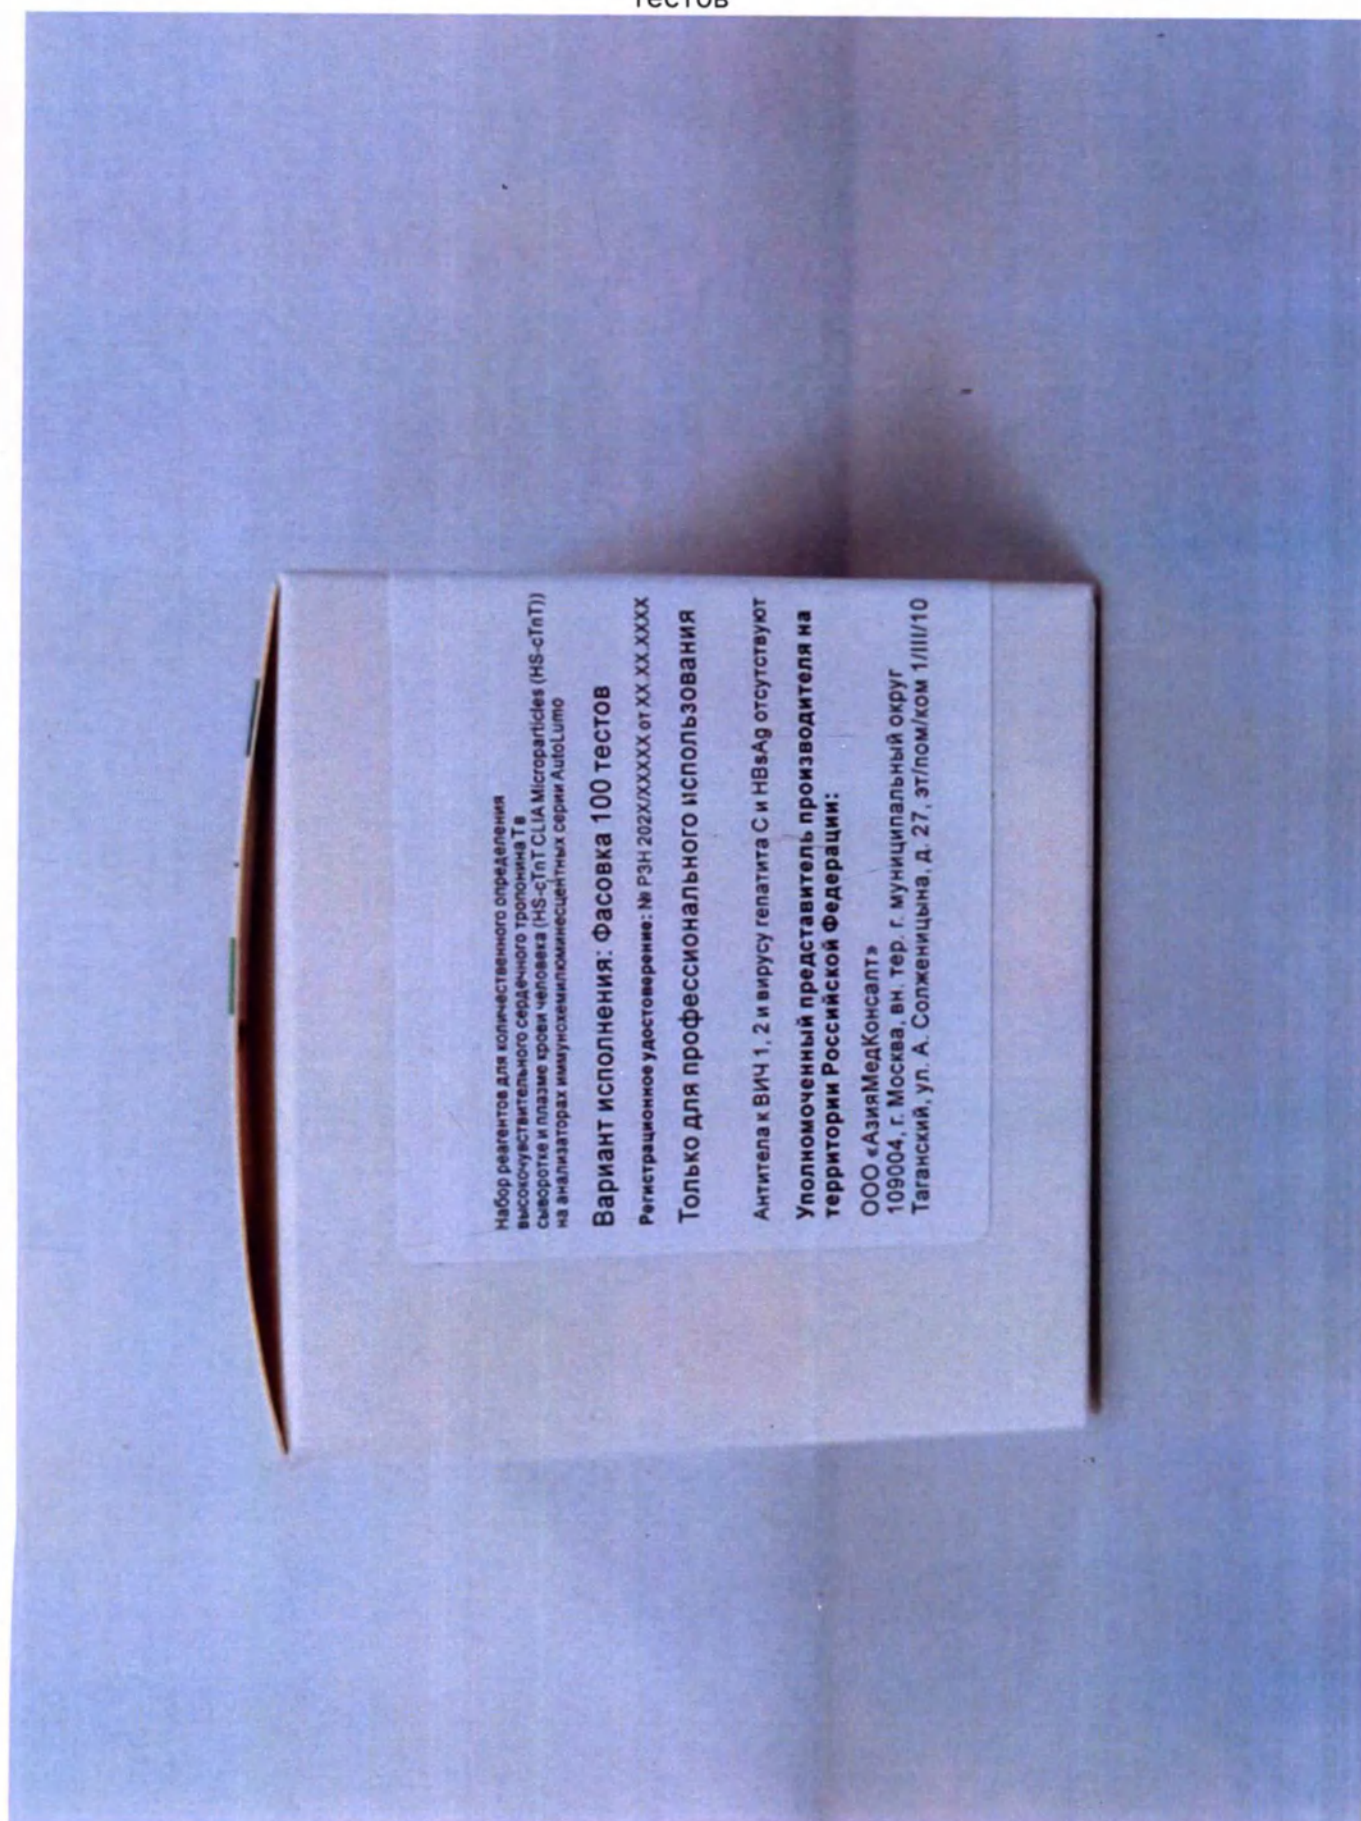



Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов



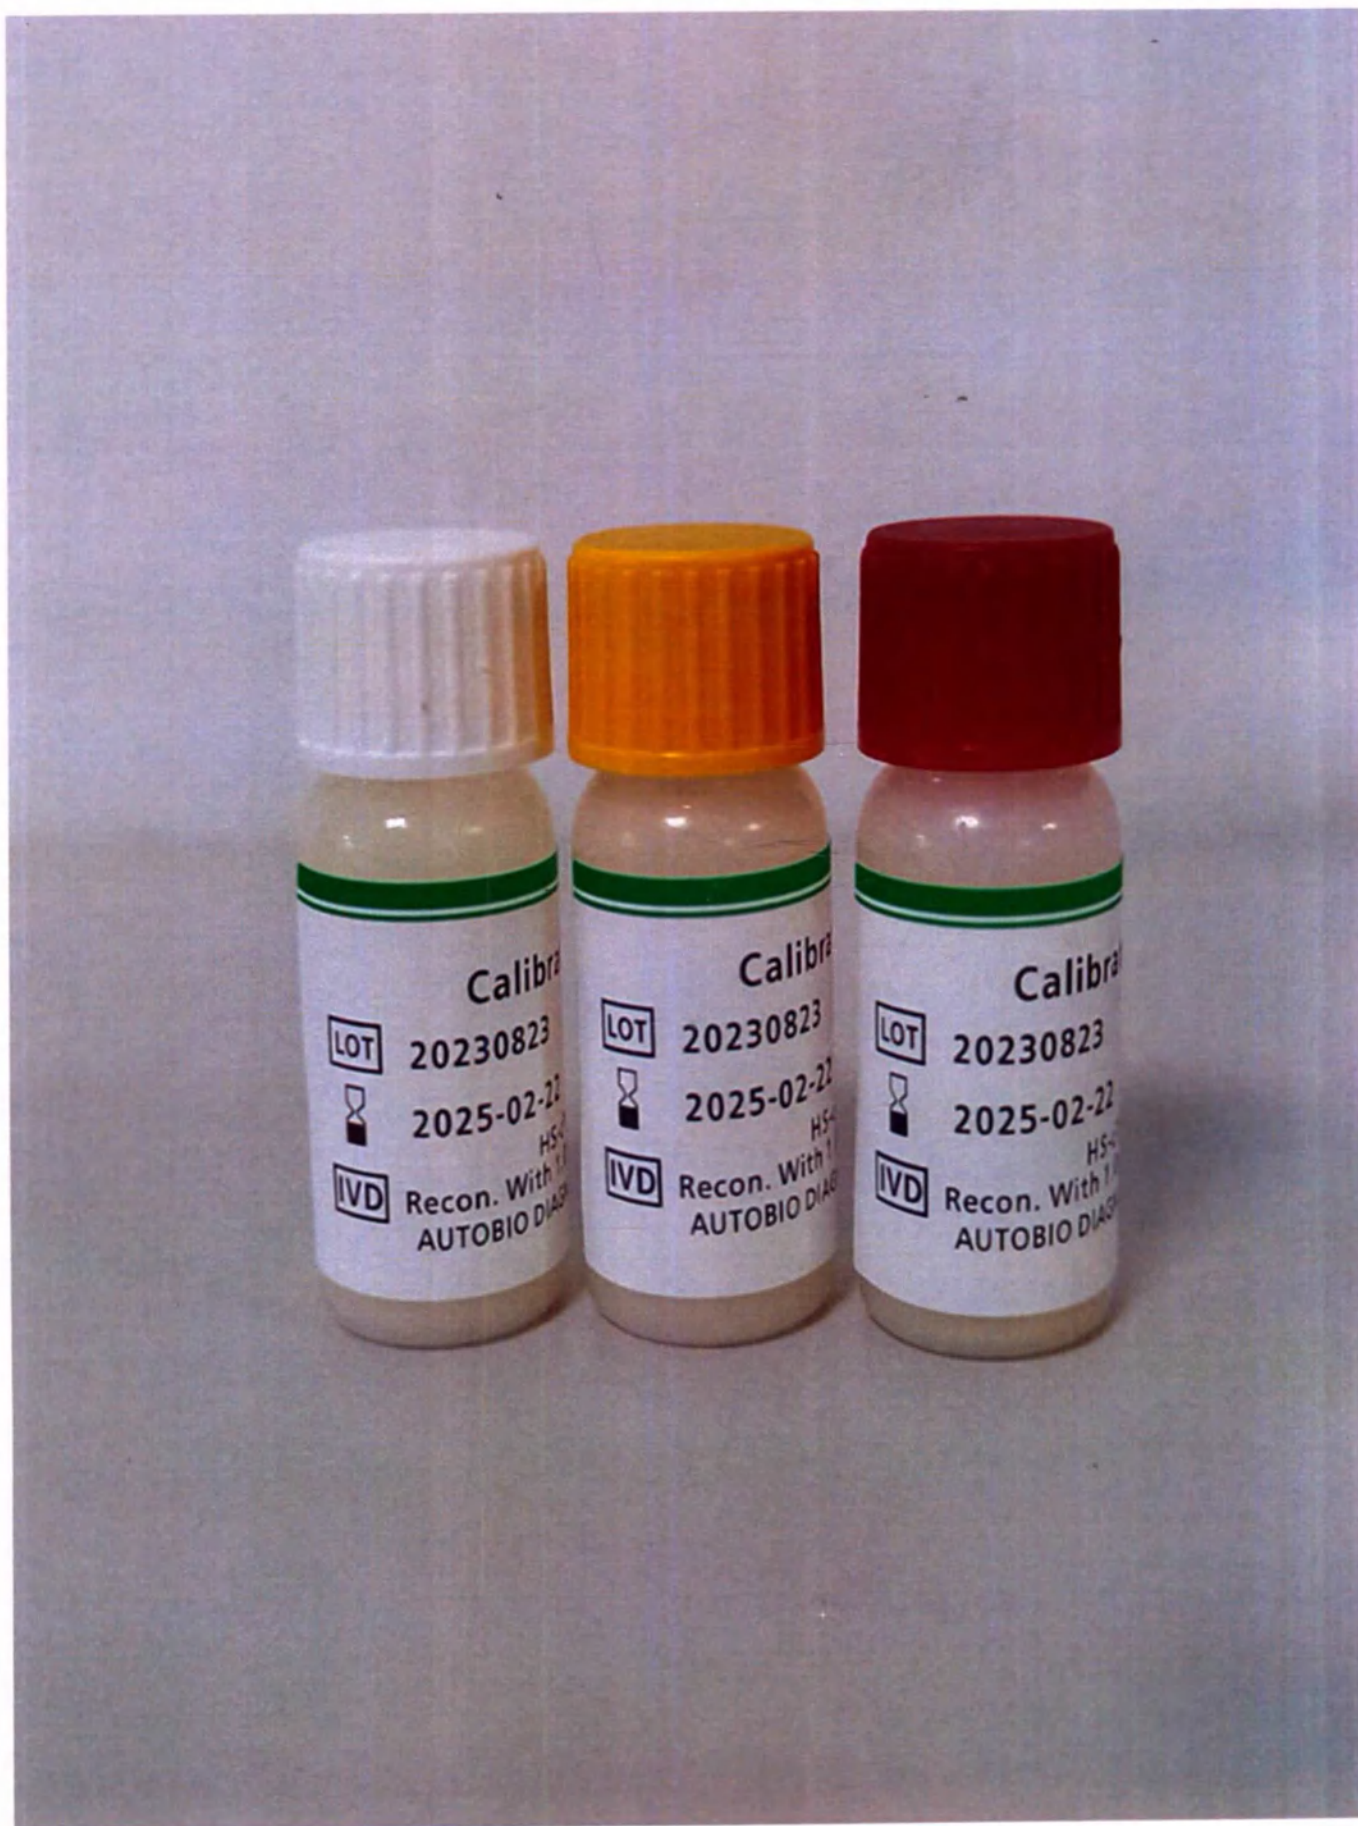






Фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и
высокого уровня (Quality control 2)







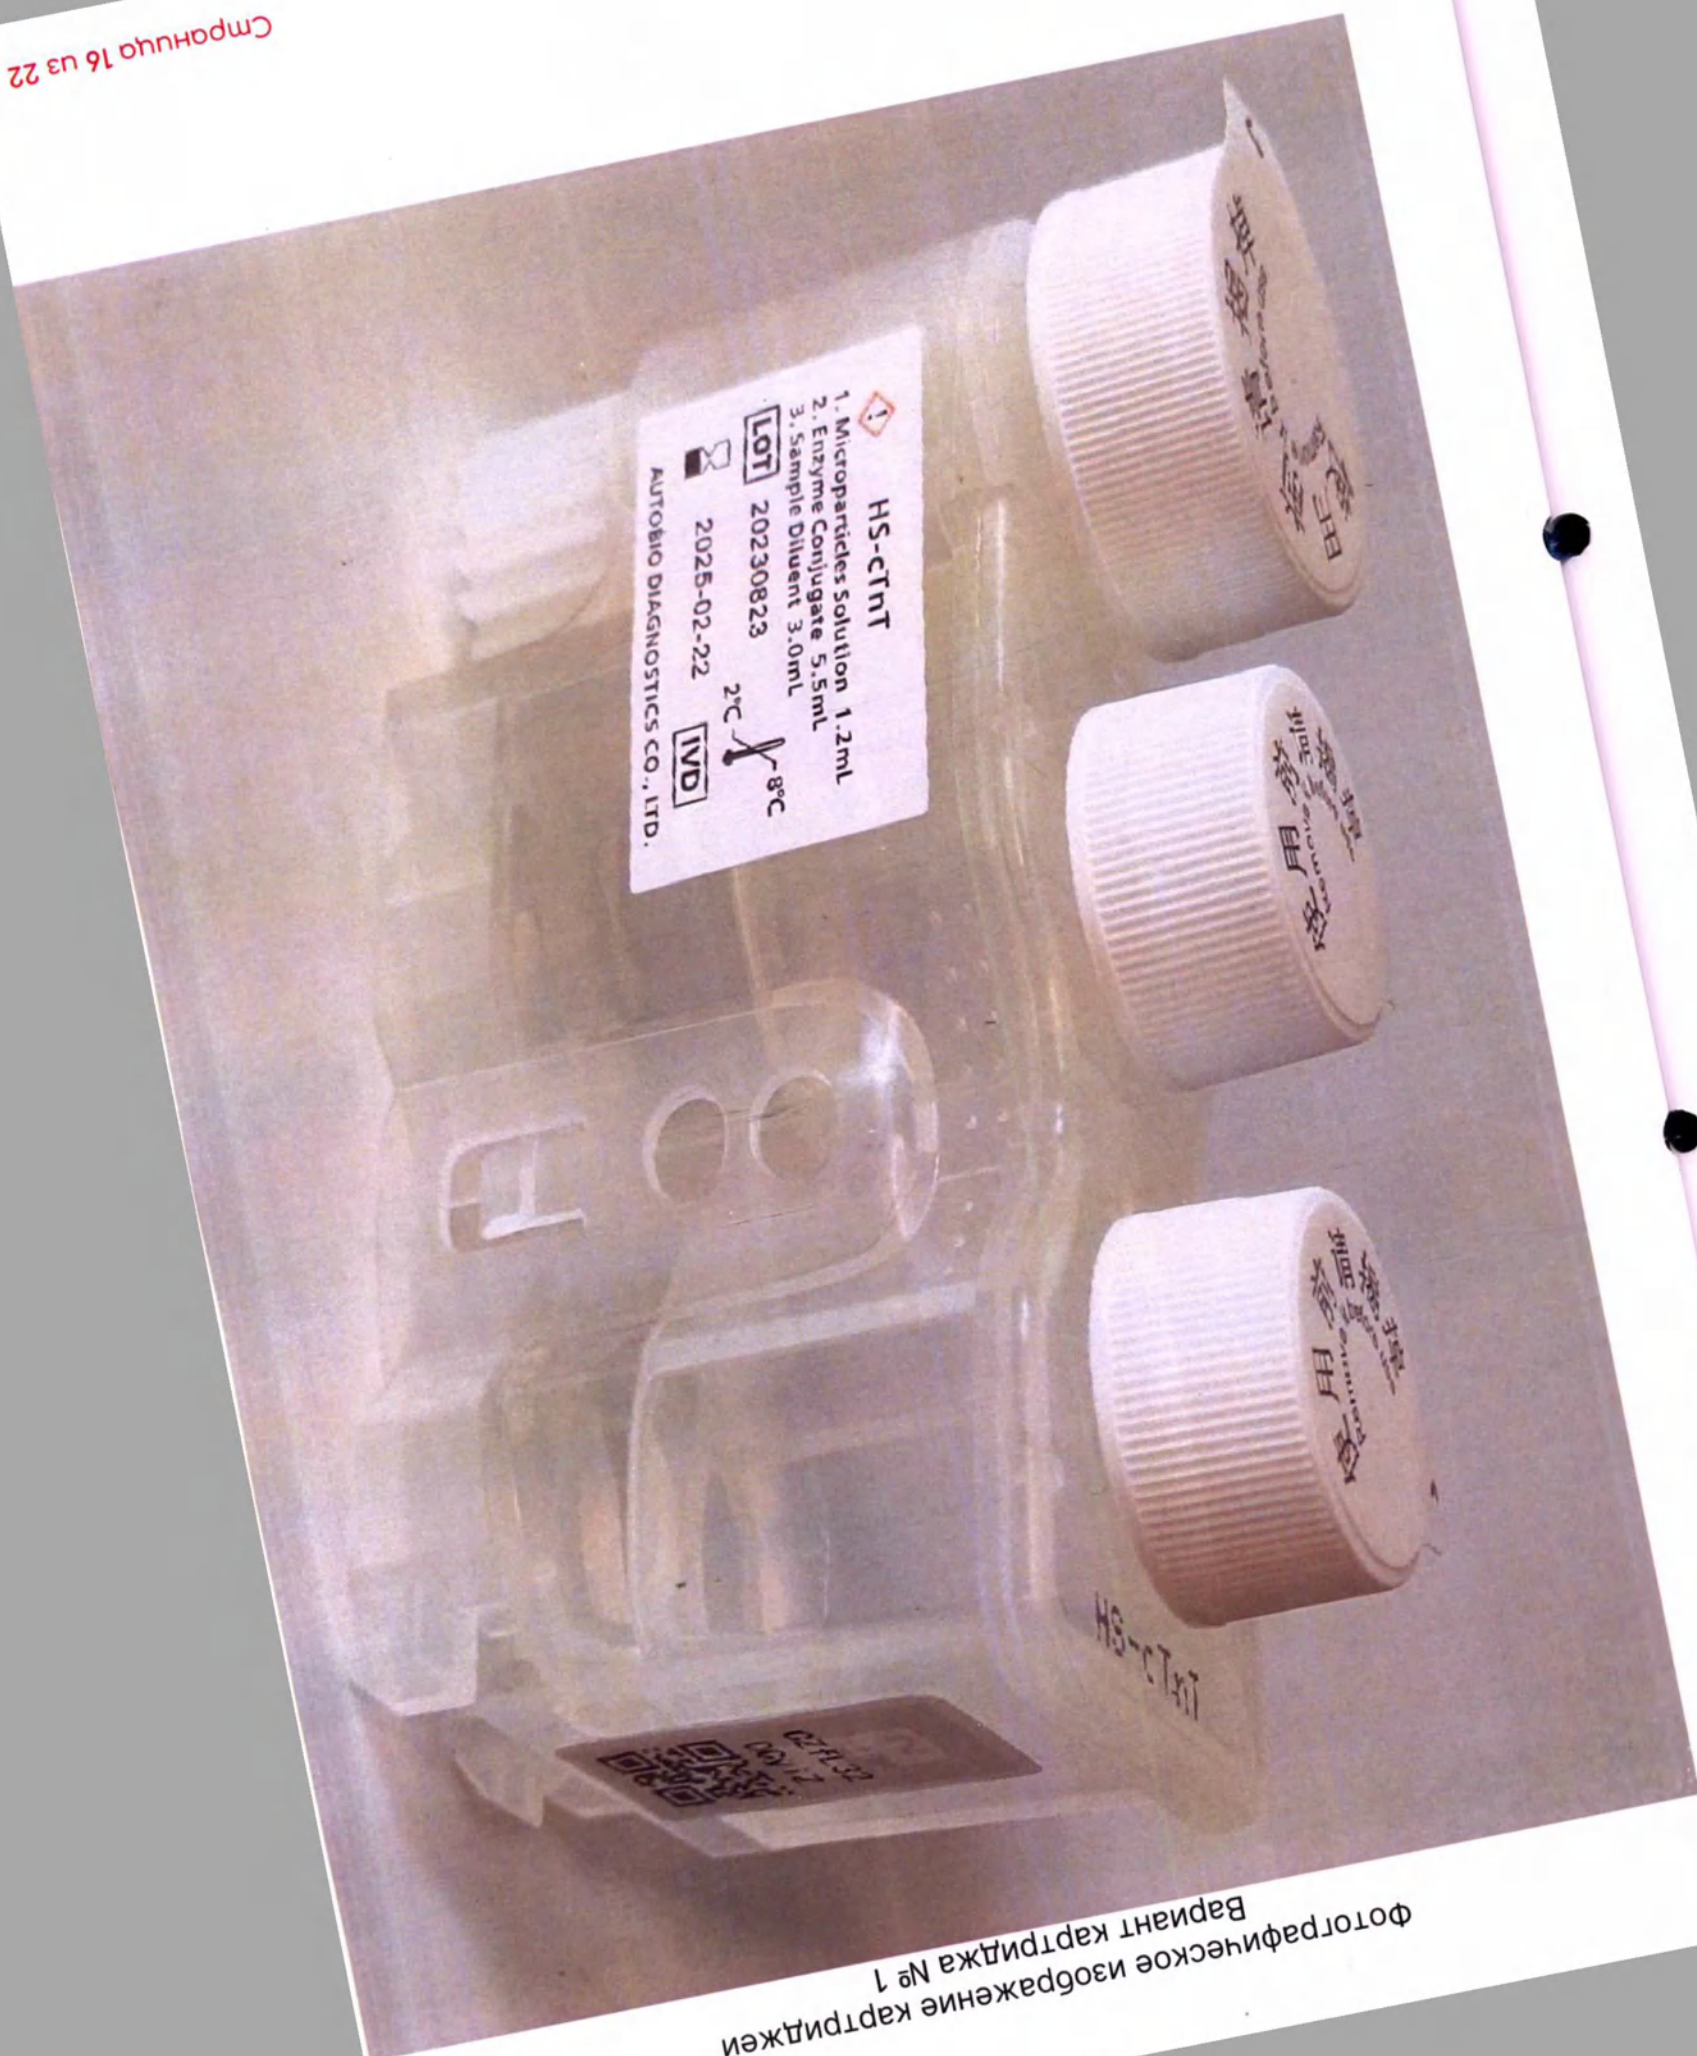

Фотографическое изображение картриджа
Вариант картриджа № 1

Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 2



Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного сердечного тропонина Т в сыворотке и плазме крови человека (HS-cTnT CLIA Microparticles (HS-cTnT)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

HS-cTnT CLIA Microparticles

REF CMH0602

LOT



Microparticles Solution 2.3mL×1

Enzyme Conjugate 11.0mL×1

Sample Diluent 5.5mL×1


IVD Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Calibrator C ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного сердечного тропонина Т в сыворотке и плазме крови человека (HS-cTnT CLIA Microparticles (HS-cTnT)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

HS-cTnT CLIA Microparticles

REF CMH0605

LOT



Microparticles Solution 1.2mL×2

Enzyme Conjugate 5.5mL×2

Sample Diluent 3.0mL×2


IVD Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Calibrator C ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Calibrator A

LOT




IVD



HS-cTnT

Recon. With 1.0mL Distilled Water

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C



Calibrator B

LOT




IVD



HS-cTnT

Recon. With 1.0mL Distilled Water

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C



Calibrator C

LOT




IVD



HS-cTnT

Recon. With 1.0mL Distilled Water

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C



Quality Control 1

LOT




IVD



HS-cTnT

Recon. With 1.0mL Distilled Water

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C



Quality Control 2

LOT




IVD



HS-cTnT

Recon. With 1.0mL Distilled Water

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C






HS-cTnT

1. Microparticles Solution 1.2mL
2. Enzyme Conjugate 5.5mL
3. Sample Diluent 3.0mL

LOT



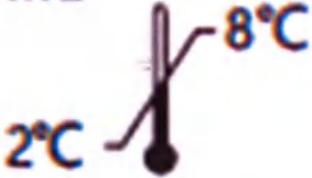

IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.




HS-cTnT

1. Microparticles Solution 2.3mL
2. Enzyme Conjugate 11.0mL
3. Sample Diluent 5.5mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(двадцати двух)

листах

